

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Электрод биполярный эндокардиальный стимулирующий/
воспринимающий и дефибриллирующий RELIANCE 4-
FRONT», в вариантах исполнения**

Boston
Scientific

RELIANCE 4-FRONT™

REF 0653


2024-02-09

SN 165583

2022-02-09

70cm

(1)



DF4-LLHH

STERILE

MD



Boston.com

100



(01)00802526595801(17)240209(21)165583

999999-999

Рисунок 1 Фотография маркировки на лицевой стороне вторичной упаковки на примере «Электрода биполярного эндокардиального стимулирующего/ воспринимающего и дефибриллирующего RELIANCE 4-FRONT», двуспирального, с активной фиксацией (спиралью), длиной: 70 см, номер модели 0653



Рисунок 2 Пример маркировки на боковой стороне вторичной упаковки

RELIANCE 4-FRONT™

REF 0653

2024-02-09

SN 165583

2022-02-09

70
cm

Integrated Signal Transducer and Refractometer Lead

Endo-anal. Transducer. Silicone with lubricious coating. 100% covered tip. Disposable. Single Use. MR Conditional. Sterile. Latex-free.

☒ Lead (1) Wire (1) 25.4cm (10") Connector: Red (1)
All (2) are 1.5mm diameter

Recommended lead introduction

Introduce at least 10cm into rectum

or (1.7 inch)

A When inserting a guide wire, a larger diameter will be needed.

Lead contains 0.36 mg barium sulfate per patient.

CAUTION: Use at 20°C (17°F). Specimens are permitted between 10°C to 30°C (50°F to 86°F). Temperature spikes are permitted up to 50°C (122°F).

If connector lead is broken, Boston Scientific will not accept returns for analysis or repair.

Cable Monitor Integrable para Refractómetro Endo-anal y Rectal

Endo-anal. Transducer. Silicona de recubrimiento lubricante. 100% cubierta de punta. Desechable. Única utilización. Compatible con RM. Sin látex.

☒ Cable (1) Transductor de sonda (1) Conector: Rojo (1)
Todos (2) tienen 1.5 mm de diámetro

Recomendación de introducción de cable

Introduzca al menos 10 cm al recto

o (1.7 inch)

A Para introducir una guía de mayor diámetro, se necesitará un transductor más grande.

El cable contiene 0.36 mg de sulfato de bario por paciente.

PRECAUCIÓN: Utilizar a 20 °C (17 °F). Se permiten intervalos de temperatura entre 10 °C y 30 °C. Se permiten picos de temperatura hasta 50 °C (122 °F).

Si el cable del transductor se rompe, Boston Scientific no aceptará el producto para análisis o reparación.



5940229-001

1

Boston Scientific Corporation
4700 Randall Avenue South
St. Paul, MN 55112-4700 USA

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
SULLIVAN ISLAND NSW Australia
Free Phone 1 800 476 133
Free Fax 1 800 834 664

999999-999

9348183-001A



EC REP

Baldwin Europe NV/SA
Boston Scientific
Groot Square, Leuvensestraat 50
3021 Belgium

CE 2797

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Veststraat 6, 6458 BX Eindhoven, The Netherlands

Made in USA
No. 12, Road 696
Daejeon, P.O. Box 90545



(01)00802526995801(17)240209(21)165583

Boston
Scientific

Рисунок 3 Пример маркировки на задней стороне вторичной упаковки

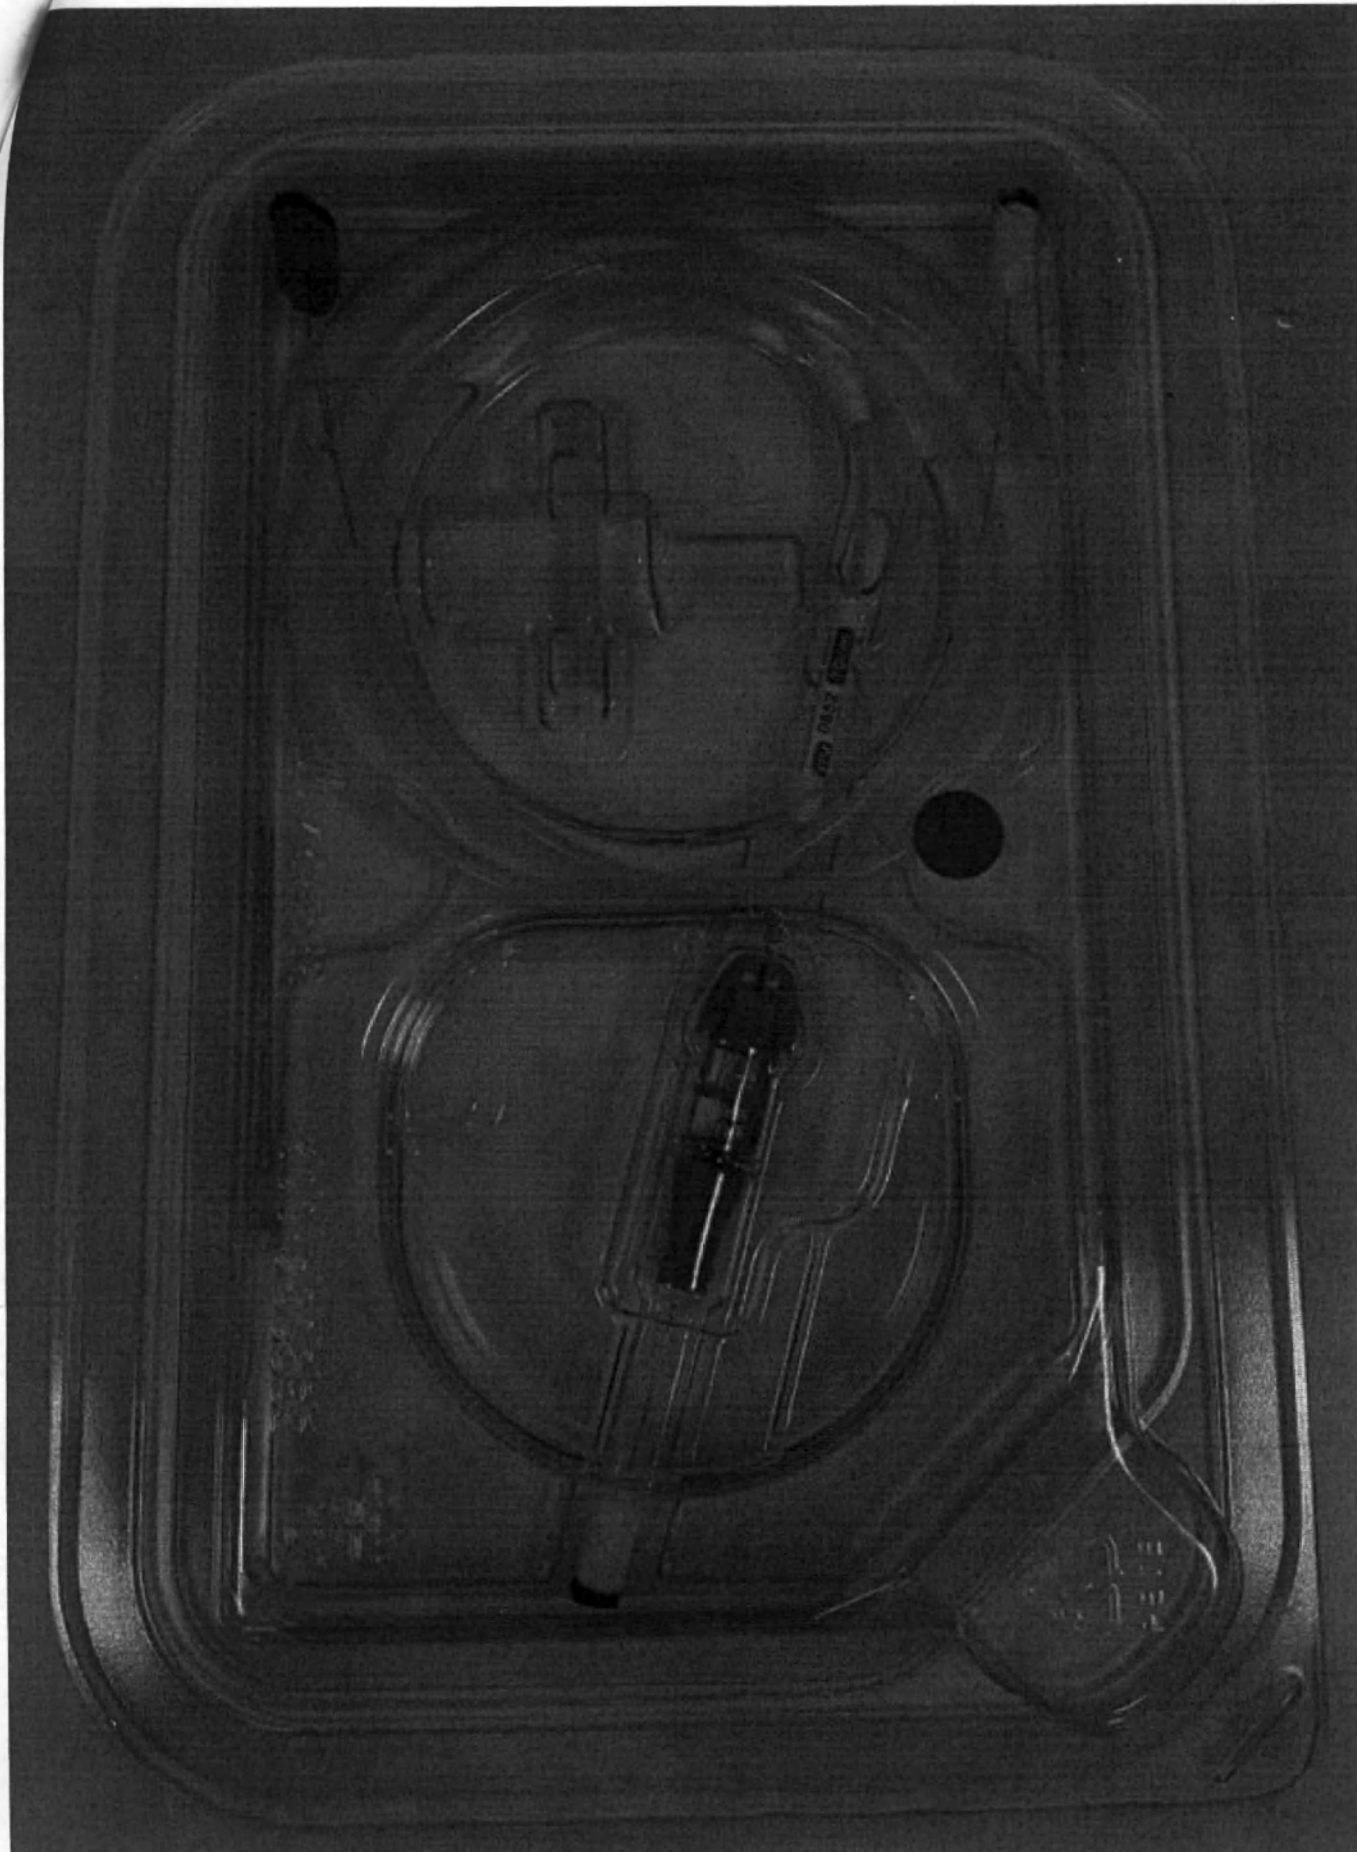


Рисунок 5 Фотографическое изображение изделия