

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
_____ 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

« Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10)»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

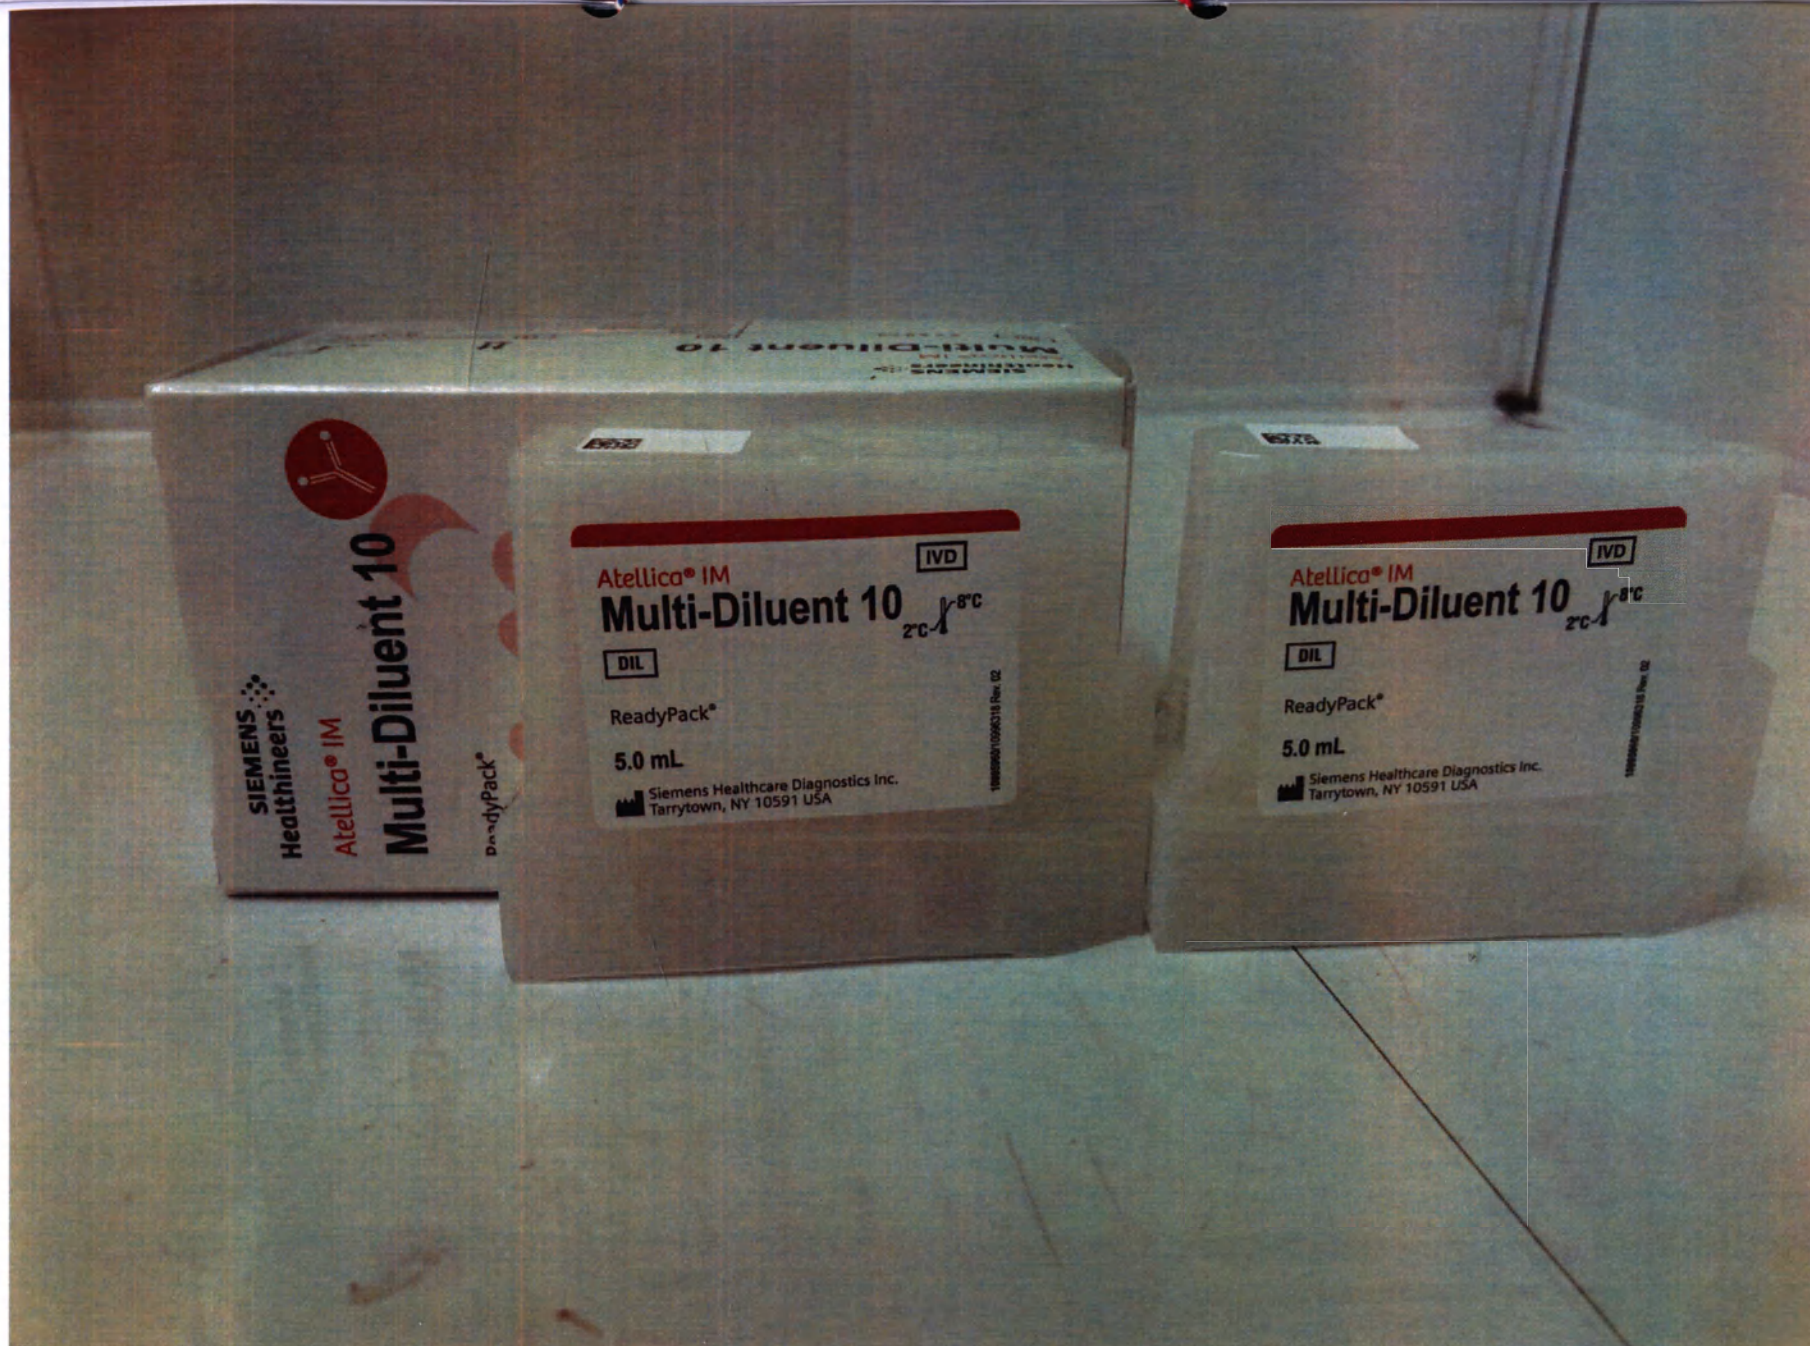


Рисунок 1. Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10). Общий вид

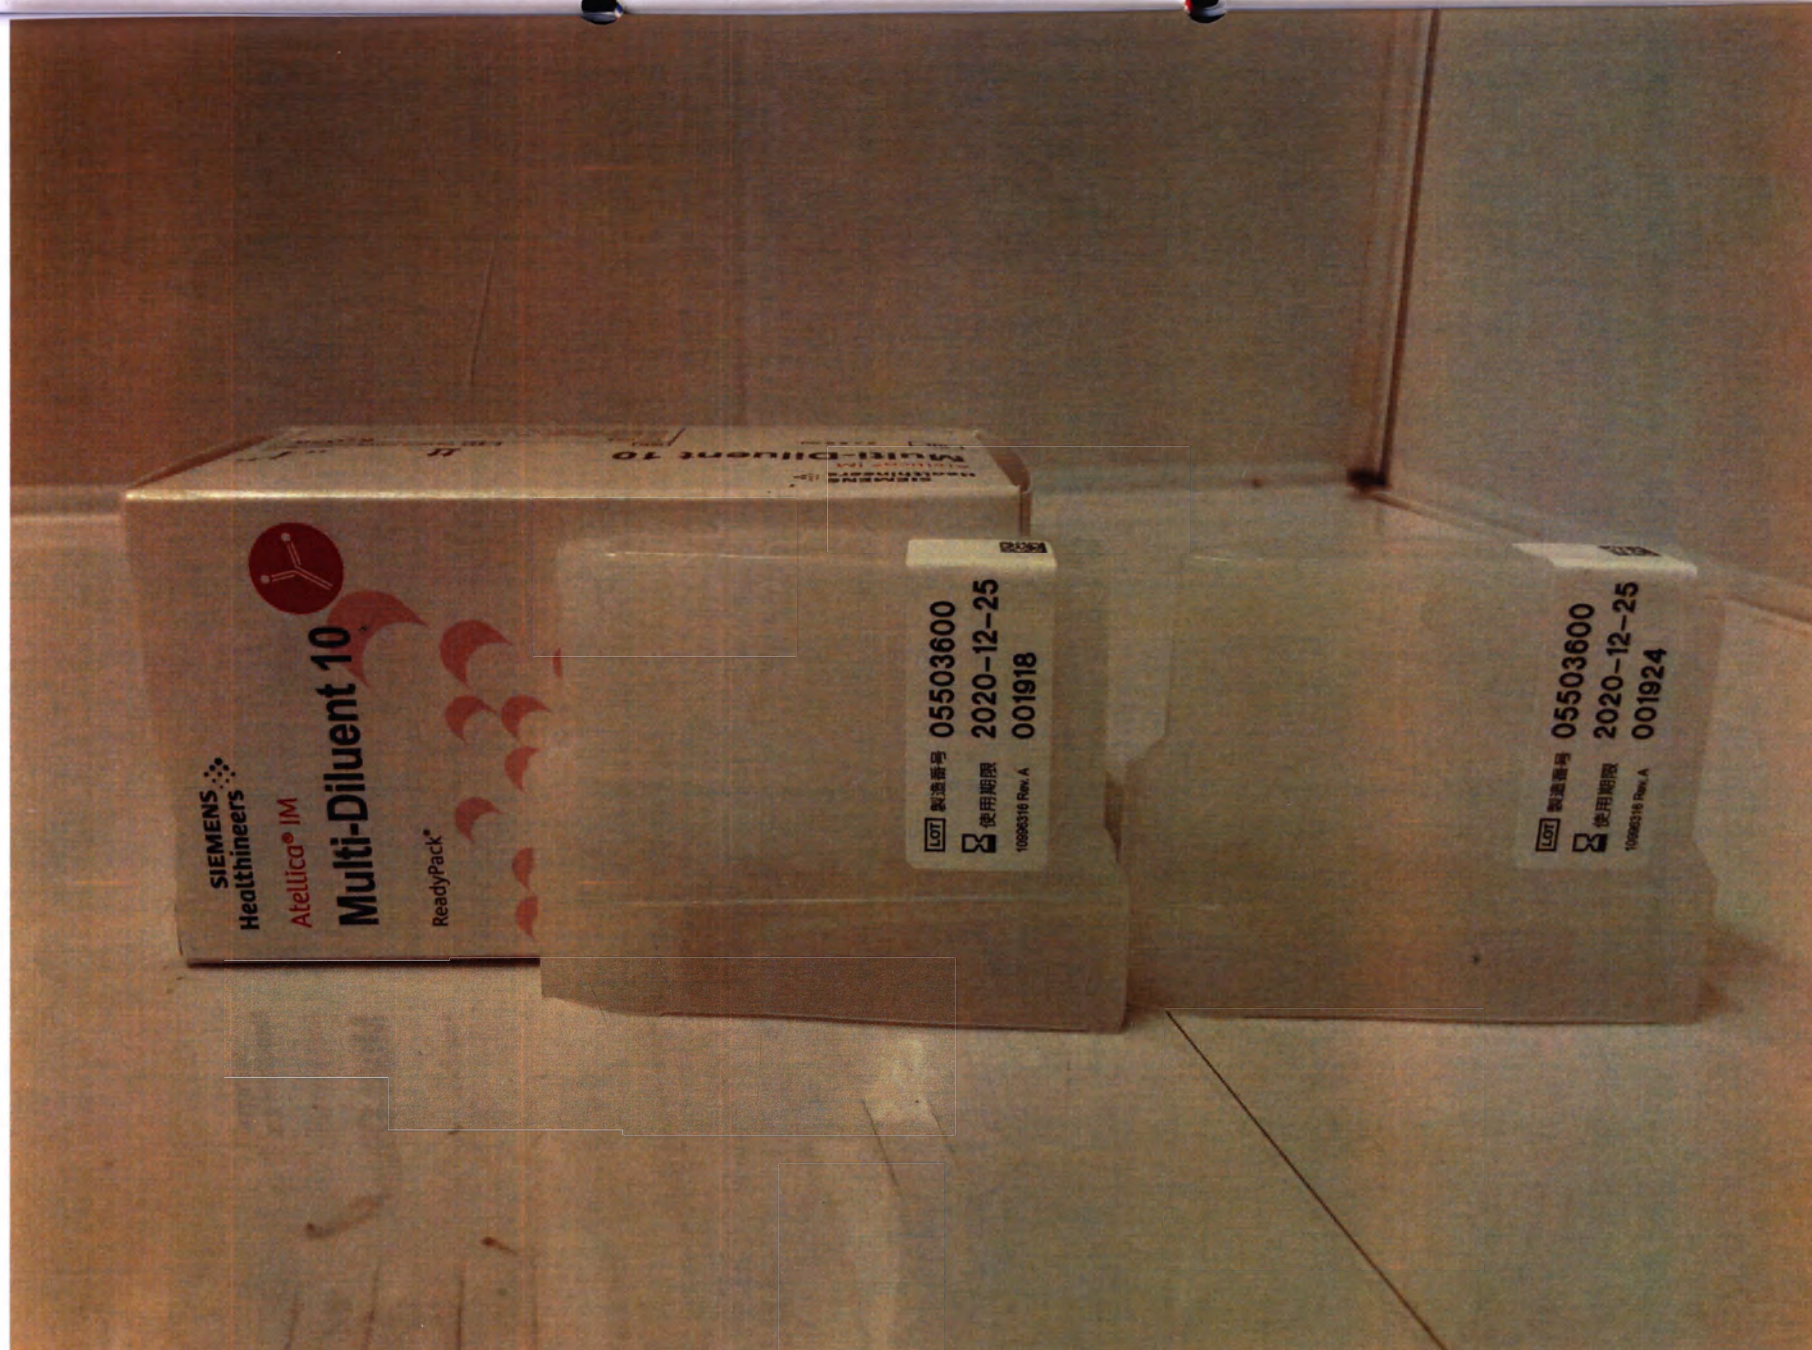


Рисунок 2. Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серий Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10). Общий вид

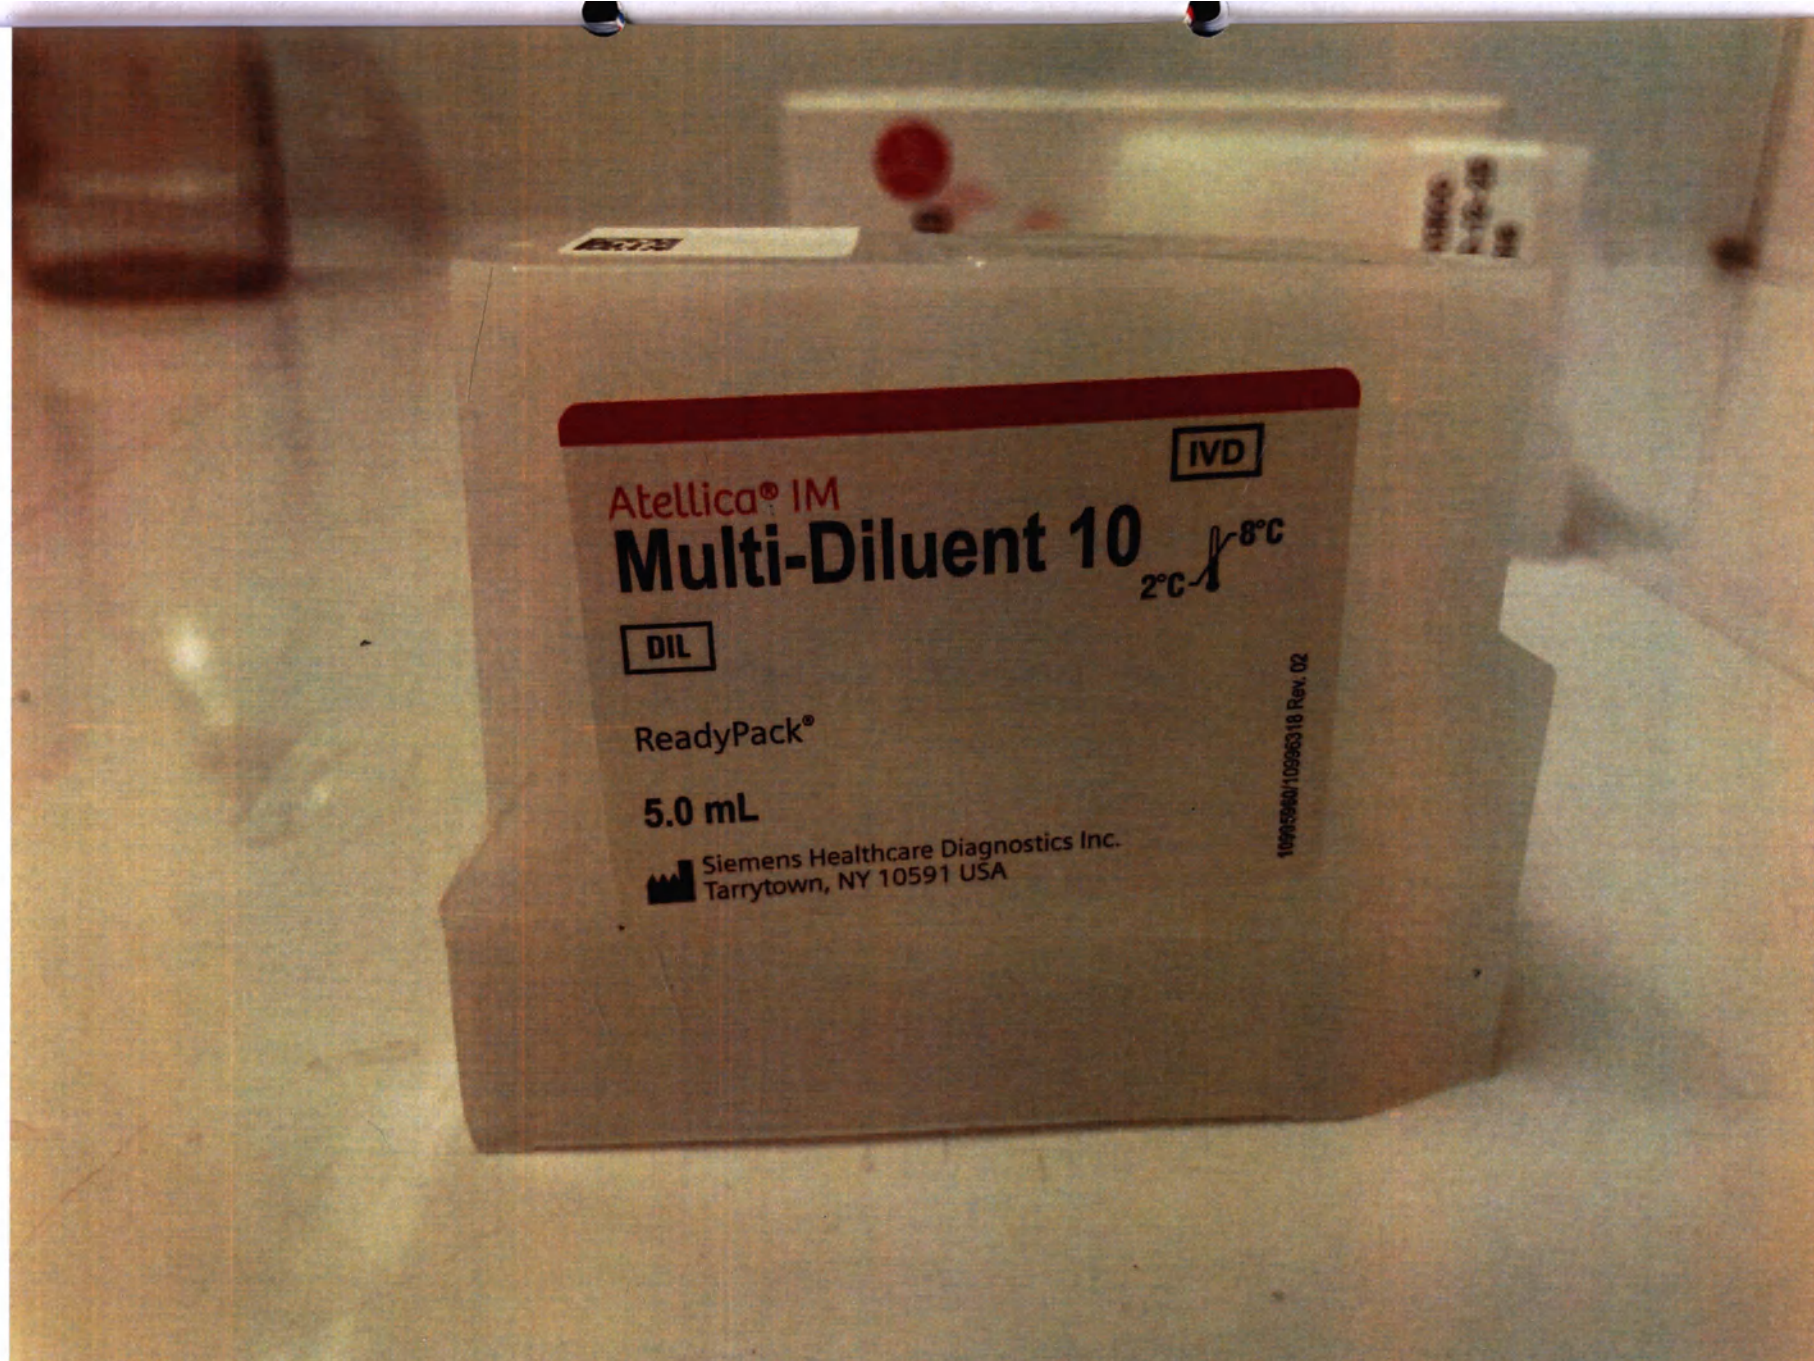


Рисунок 3. Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10): Мульти-Дилуэнт 10 (Atellica IM Multi-Diluent 10) – 5,0 мл/упаковка

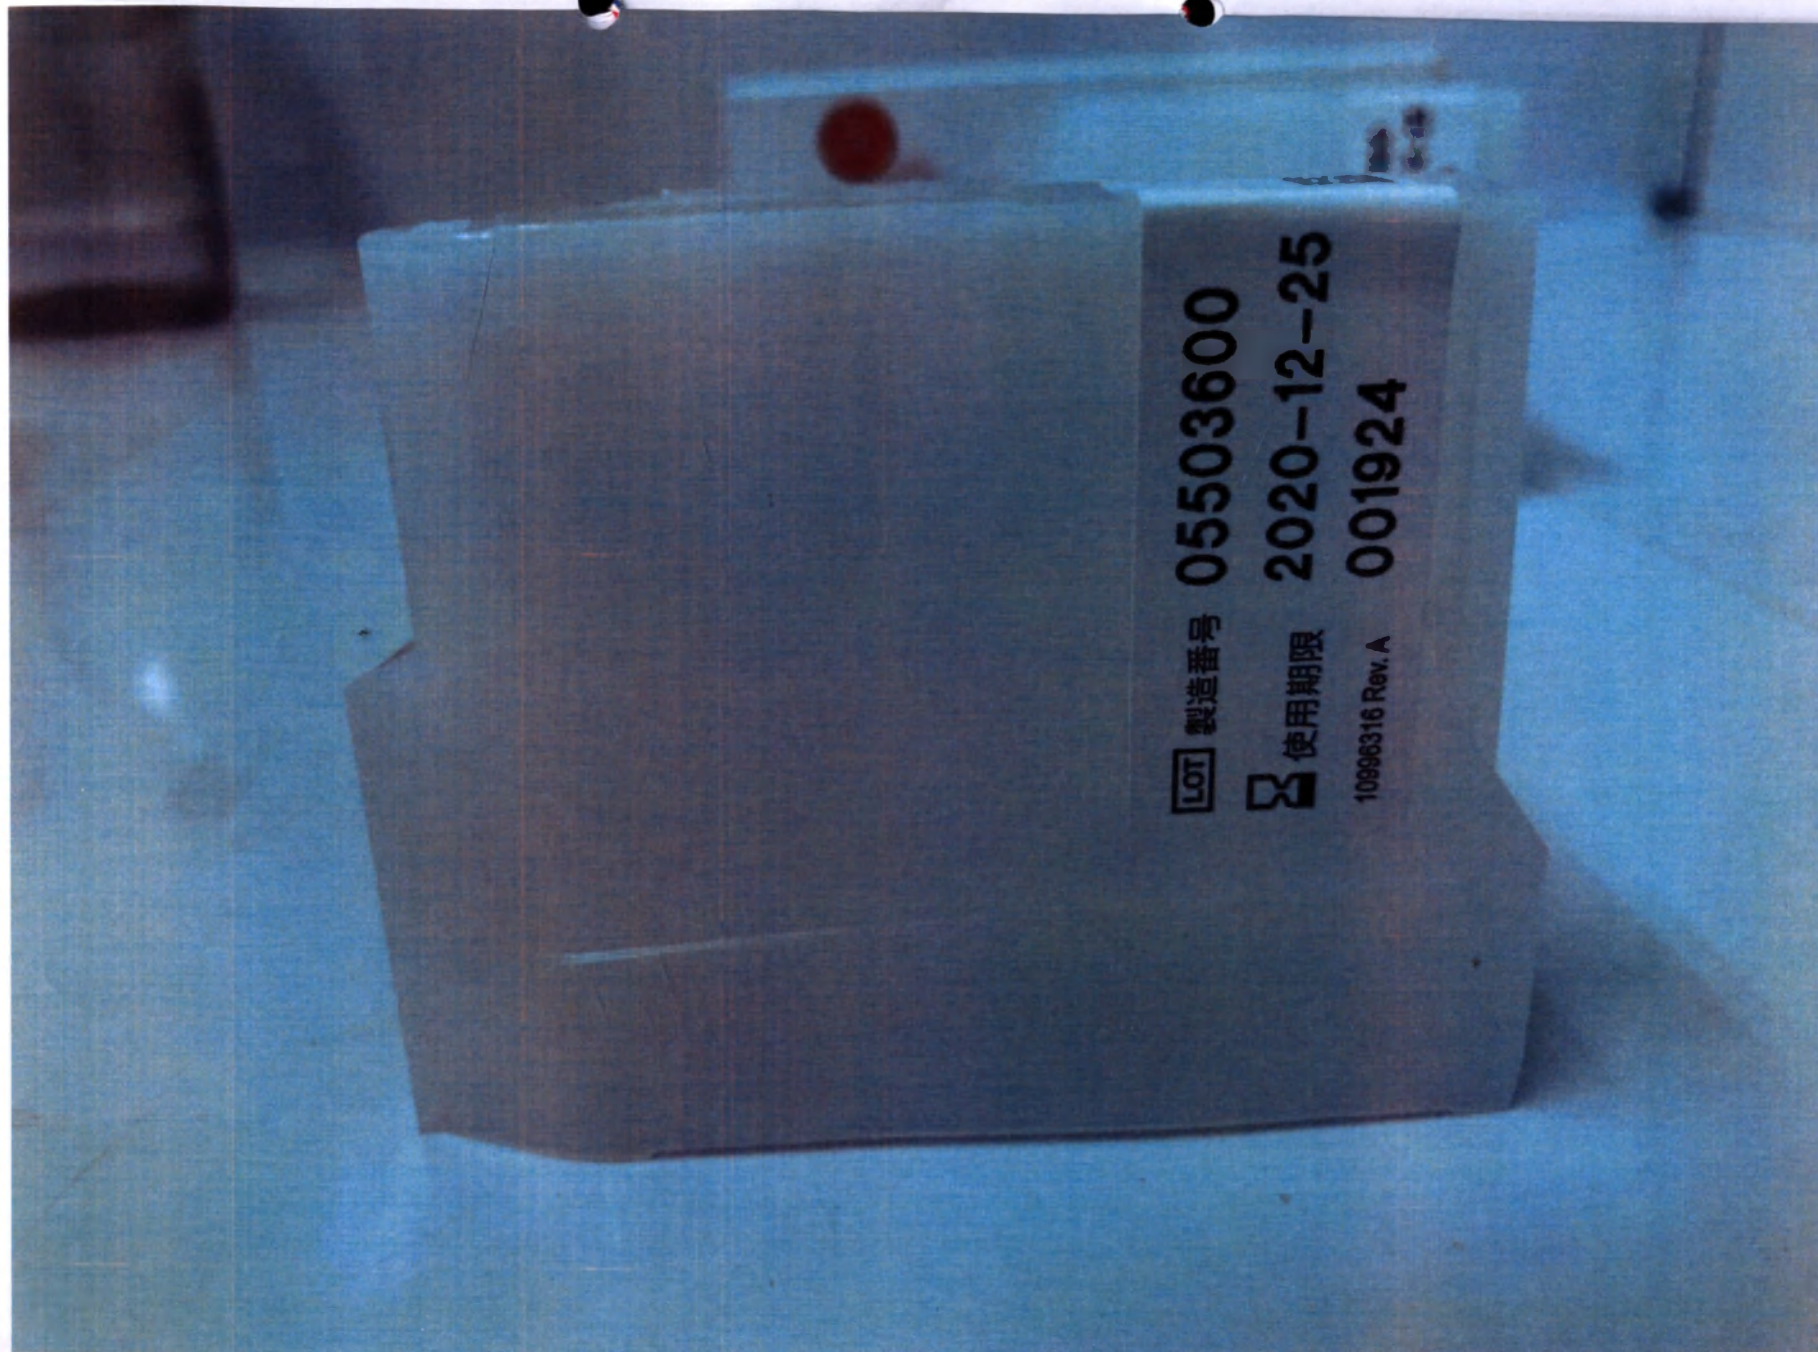


Рисунок 4. Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10): Мульти-Дилуэнт 10 (Atellica IM Multi-Diluent 10) – 5,0 мл/упаковка

Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»





October 12, 2020

To Whom it May Concern:

This is to certify that the attached document is the Labels of Medical Device:

Atellica IM Multi-Diluent 10

For and on behalf of
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

511 Benedict Avenue


Tarrytown, NY 10591 USA

Idrissa Sparks-Tillman
Senior Manager, Regulatory Affairs

Notary Public

Tammy Cave
Notary Public, State of New York
Registration No. 01CA6384044
Qualified in Westchester County
My Commission Expires December 3, 2022

Labels of the medical device:
Atellica IM Multi-Diluent 10
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

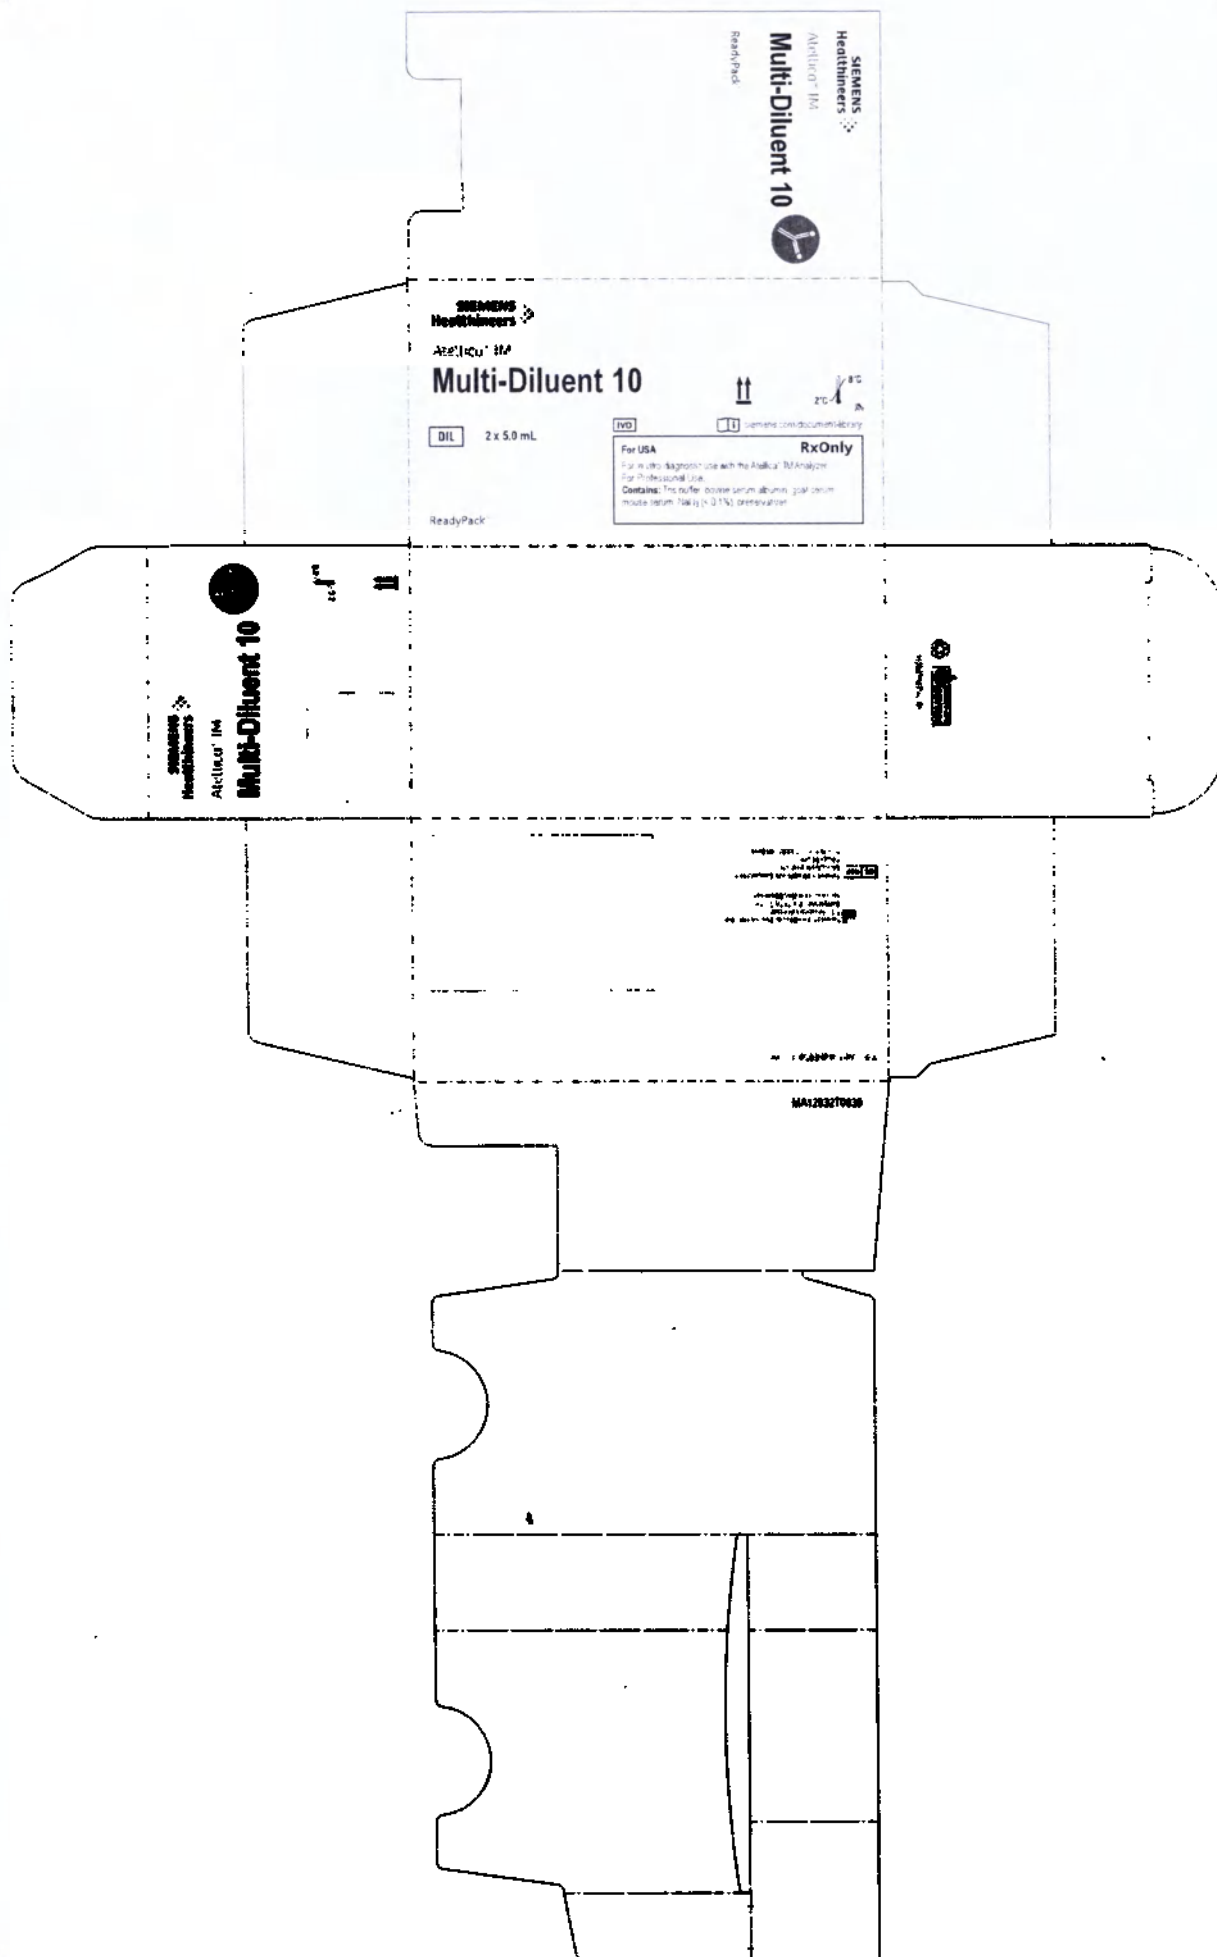

The additional label for Russia which is pasted on the external box:

10995640 Мульти-Дилуент 10 для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-
Diluent 10)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Atellica® IM

IVD

Multi-Diluent 10

2°C - 8°C

DIL

ReadyPack®

5.0 mL

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

1000000 ReadyPack 1000000

12 октября 2020 г.

По месту требования:

Настоящим удостоверяется, что прилагаемый документ является Маркировкой медицинского изделия:

«Мульти-Дилуэнт 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10)»

От имени и по поручению
«Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»
(Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)

/Подпись/

Идрисса Спаркс-Тиллман (Idrissa
Sparks-Tillman)
Старший менеджер, отдел регистрации
и сертификации

/Печать/:

«Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.»
(Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)

511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA (США)

/Подпись/

Нотариус

/Штамп/:

Тамми Кейв
НОТАРИУС, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК
Лицензия № 01СА6384044
Получила лицензию на осуществление нотариальной
деятельности на территории округа Вестчестер
Срок моих полномочий истекает 03.12.2022 г.

Маркировка медицинского изделия:

"Мульти-Дилуент 10 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 10)",

производства "Сименс Хелскеа Диагностика Инк.", Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

Дополнительная маркировка для Российской Федерации, которая наносится на внешнюю упаковку:

10995640 Мульти-Дилуент 10 для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-
Diluent 10)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO


Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

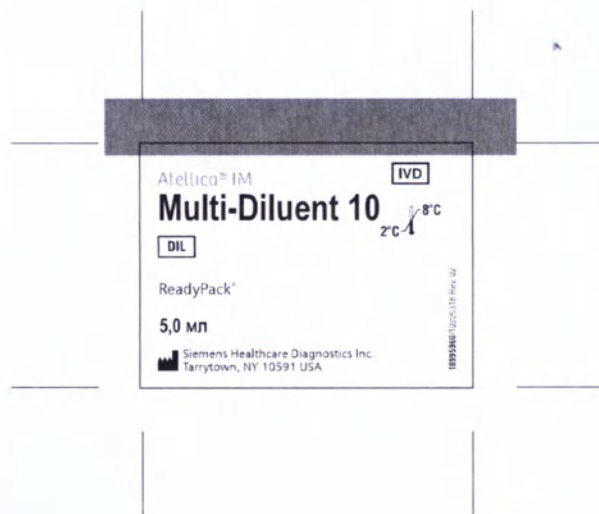

переводчик Саная Анаит Левоновна


Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи двадцать первого года

Я, Милевская Анна Анваровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Саная Анаит Левоновны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2021-9-2590.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



А.А.Милевская



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 10 - листов
ВРИО нотариуса

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго марта две тысячи двадцать первого года

Я, Милевская Анна Анваровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дударева Александра Владимировича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/178-н/77-2021-9-2671.

Уплачено за совершение нотариального действия: 660 руб. 00 коп.



[Signature]

А.А.Милевская



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью — 19 — листов
ВРИО нотариуса *[Signature]*