



ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
123112, г. Москва, Россия,
ул. Тестовская, дом 10, этаж 13,
помещение I, офис 5
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com

Генеральный директор ООО "Терумо Рус"


Уэно Минору

"1" *апреля* 2021 г.




Фотографические изображения медицинского изделия:

Датчик шунтирующий CDI с гепариновым покрытием, модель CDIS10H, для системы мониторинга параметров крови CDI

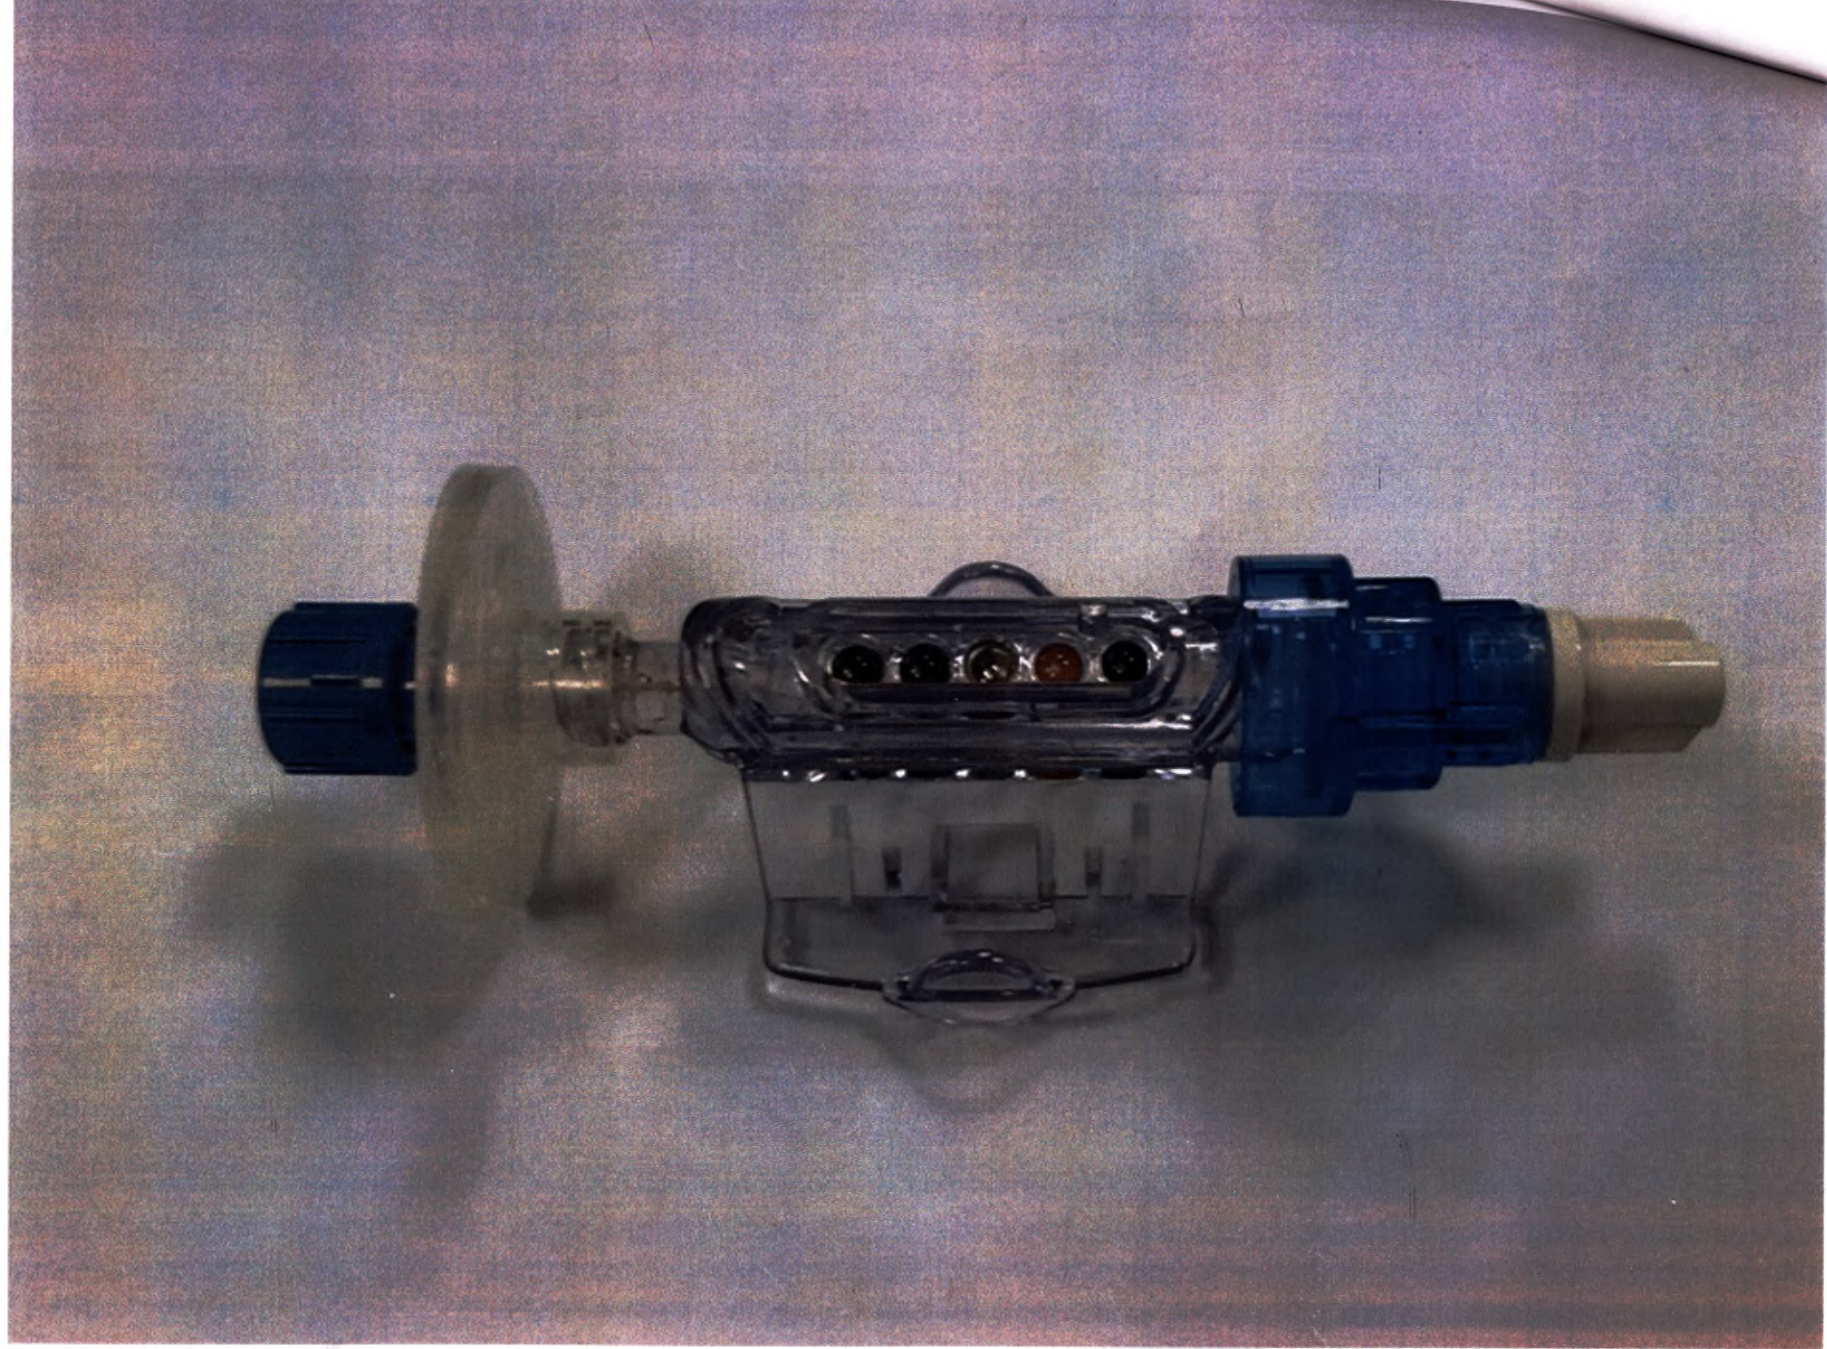

Датчик шунтирующий CDI с гепариновым покрытием, модель CDI510H, для системы мониторинга параметров крови CDI – внешний вид изделия

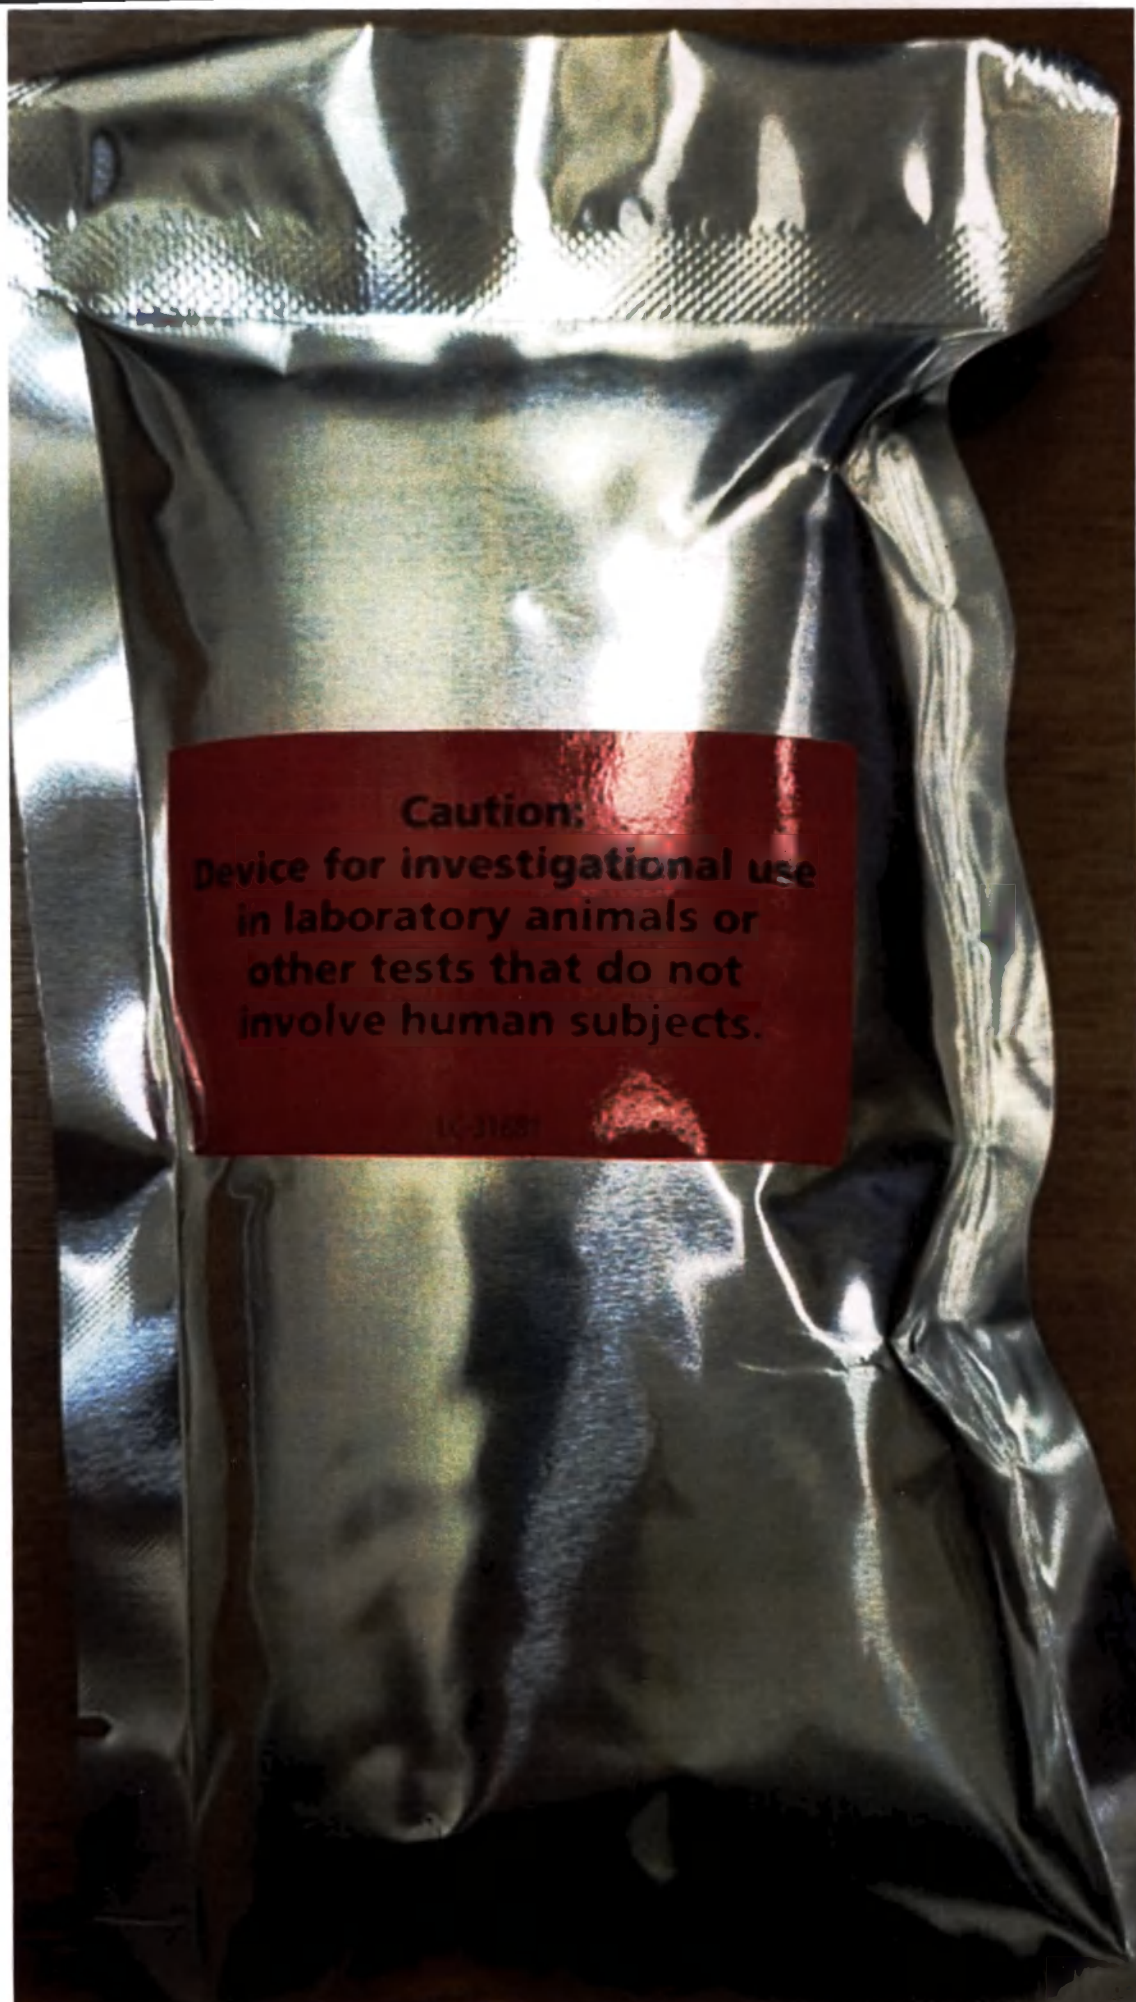



Датчик шунтирующий CDI с гепариновым покрытием, модель CDI510H, для системы мониторинга параметров

REF **CDI510H**

SHUNT SENSOR with heparin treatment
 CAPTEUR D'ETALONNAGE avec traitement héparine
 SHUNT-SENSOR mit heparin-beschichtung
 SENSORE DI SHUNT con trattamento di eparina
 SENSOR DE SHUNT con tratamiento con heparina
 SHUNT-SENSOR met heparine-behandeling
 SHUNTGIVARE med heparin-behandling
 SHUNTSENSOR med heparin-behandling
 SENSOR PARA DERIVAÇÃO com tratamento com heparina
 SHUNT-SENSOR med heparin-behandling
 ΑΝΟΙΓΤΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ με Ελεξεργασία ηπαρίνης



Non-pyrogenic

Do not use
if package
is damagedFragile
handle
with careDo not
reuseDo not
resterilize

35°C
95°F
0°C
32°F
Temperature
limitation

Rx

STERILE RSterilized
using
irradiationFluid
pathCaution, consult
accompanying
documents**WARNING:** Do not open pouch until ready for calibration.**AVERTISSEMENT:** Ne pas ouvrir l'enveloppe avant d'être prêt pour la calibration.**WARNHINWEIS:** Verpackung erst unmittelbar vor der Kalibrierung öffnen.**AVVERTENZA:** Non aprire la busta fino a quando non si è pronti per la calibrazione.**AVERTENCIA:** No abrir la bolsa hasta inmediatamente antes de la Calibración.**AVARSCHUWING:** De zak niet openen tot het moment van kalibreren.**VARNING:** Öppna inte påsen förrän du är redo att kalibrera.**ADVARSEL:** Posen bør ikke åbnes, før sensoren er klar til at blive kalibreret.**AVISO:** Não abrir a embalagem até estar pronto para a calibração.**ADVARSEL:** Åpen ikke posen før du er klar til kalibrering.**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Μην ανοίγετε το στακουλάκι μέχρι να είστε έτοιμοι για βαθύμεση

Made in USA

Manufacturer:

**TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORP.**
125 Blue Bell Rd., Elkton, MD 21921, USA**TERUMO EUROPE N.V.**, Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**TERUMO CORPORATION**, Tokyo 151-0072, JapanAll Sponsor **TERUMO CORP. AUSTRALIAN BRANCH**, NSW 2113, Australia**CE 0086**

(01)00699753160767

**LOT** XP10XX

2020-11-30

K+ Code: 674A

Датчик шунтирующий CDI с гепариновым покрытием, модель CDI510H, для системы мониторинга параметров крови CDI	
Производитель: Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Терумо Кардиоваскуляр Системс Корпорейшн), 125 Blue Bell Rd Elkton Maryland 21921, U.S.A. (США) Произведено в США	
См. REF, LOT,  на основной маркировке производителя	
STERILE       35°C / 95°F 0°C / 32°F	
Обратитесь к основной маркировке, упаковке и эксплуатационной документации производителя за нормативными сведениями и полной информацией о безопасном использовании изделия.	
 Апирогенно Нетоксично	Представитель производителя в РФ: ООО "Терумо Рус", 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт.13, пом.1, ком.5. Тел. + 7 495 988 47 40
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
5 листа (ов)

