




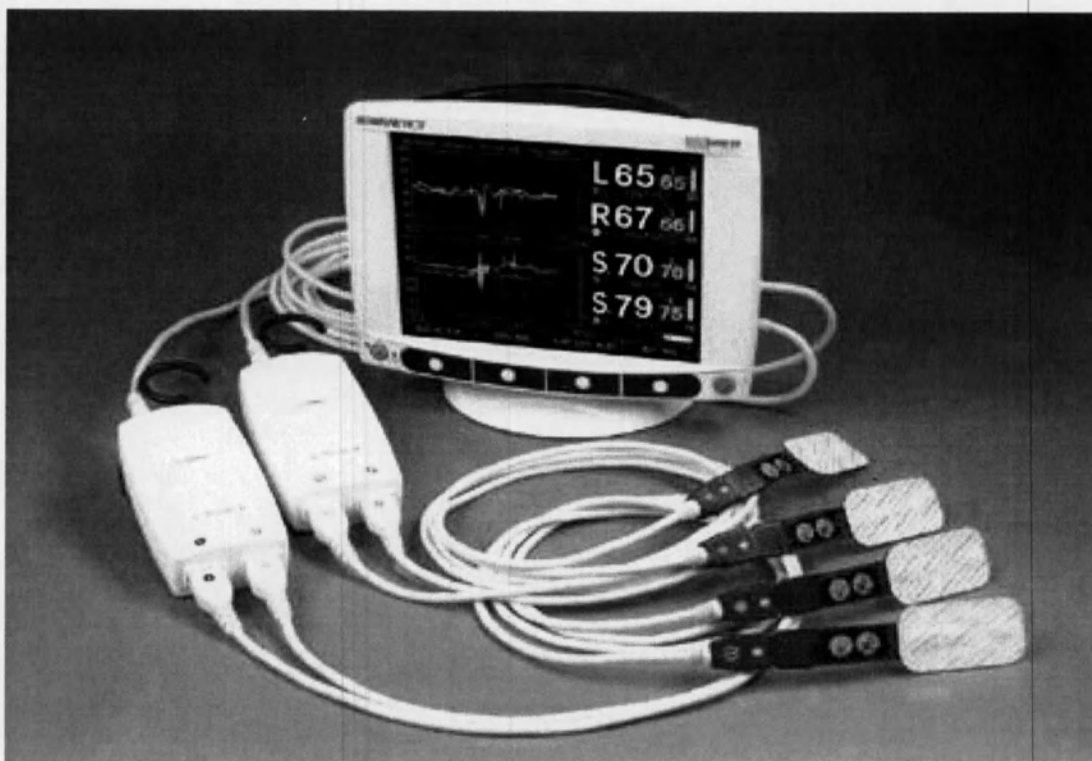

Оксиметр церебральный/соматический Invos 5100C с принадлежностями

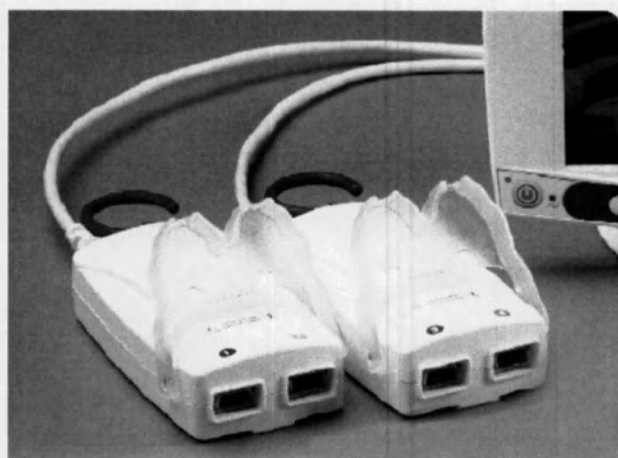

Предусилители сигнала

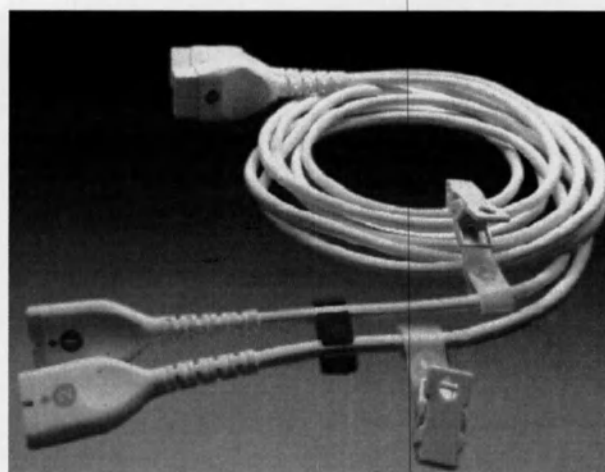

Кабели предусилителя сигнала

АКТ № 528-P/11




Оксиметр церебральный/соматический Invos 5100C
Вид сбоку




Оксиметр церебральный/соматический Invos 5100C
с USB флэш-память

АКТ № 528-П/11

- 8 -

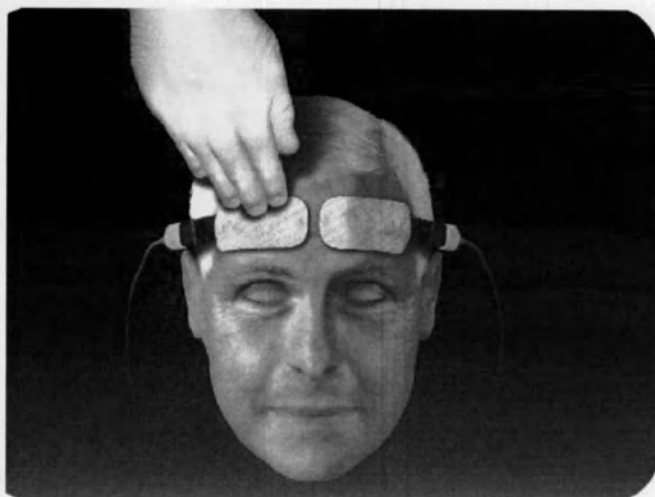

Возможная установка датчиков

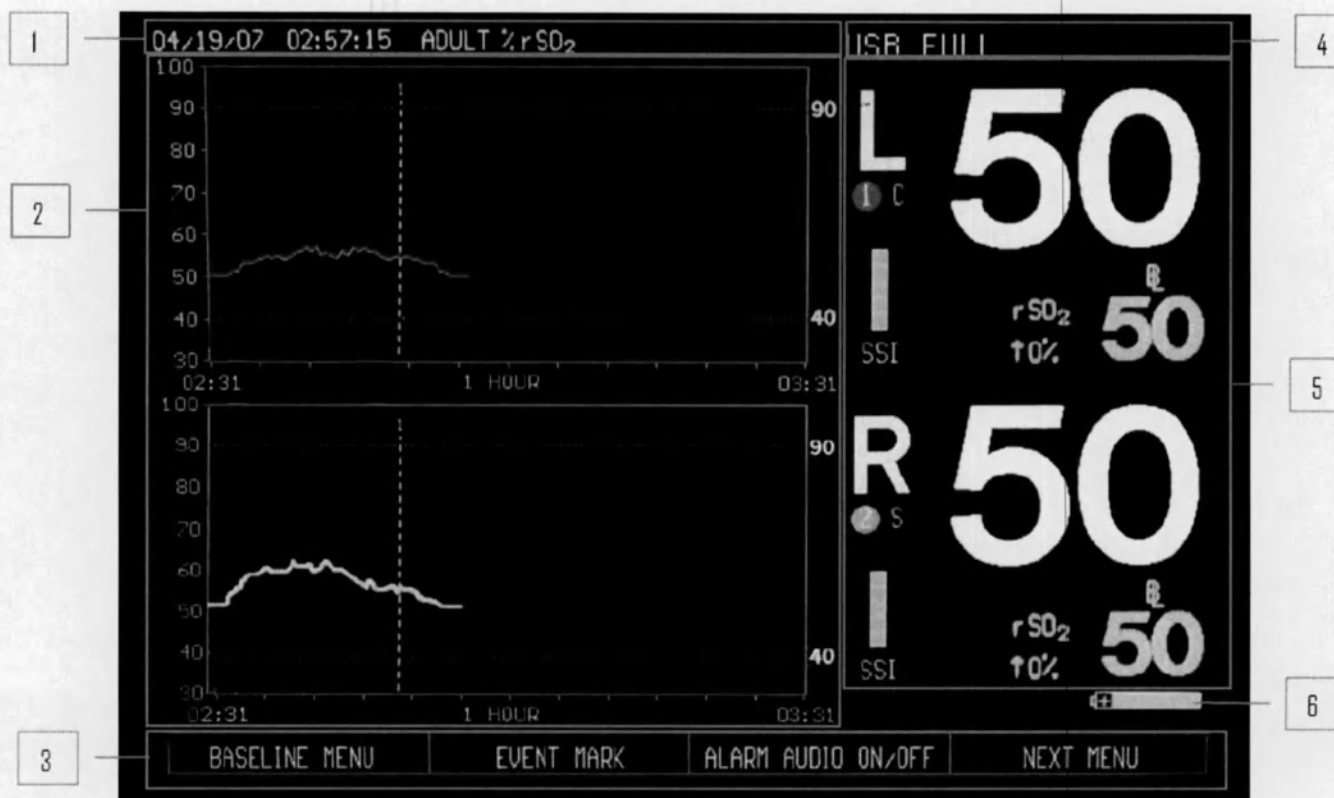

1. Дата / время и область сообщений о рабочем состоянии
2. Область графиков данных трендов
3. Навигационная линейка (пункты меню)
4. Тревожные сообщения и область символов
5. Область каналов данных (метка канала данных, базовый уровень, значения rSO_2 , SSI, сообщения о состоянии)
6. Символ батареи

АКТ № 528-Р/11