




Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями

Монитор основной блок (в составе: корпус, дисплей, системная плата, аккумуляторная батарея, термопринтер)

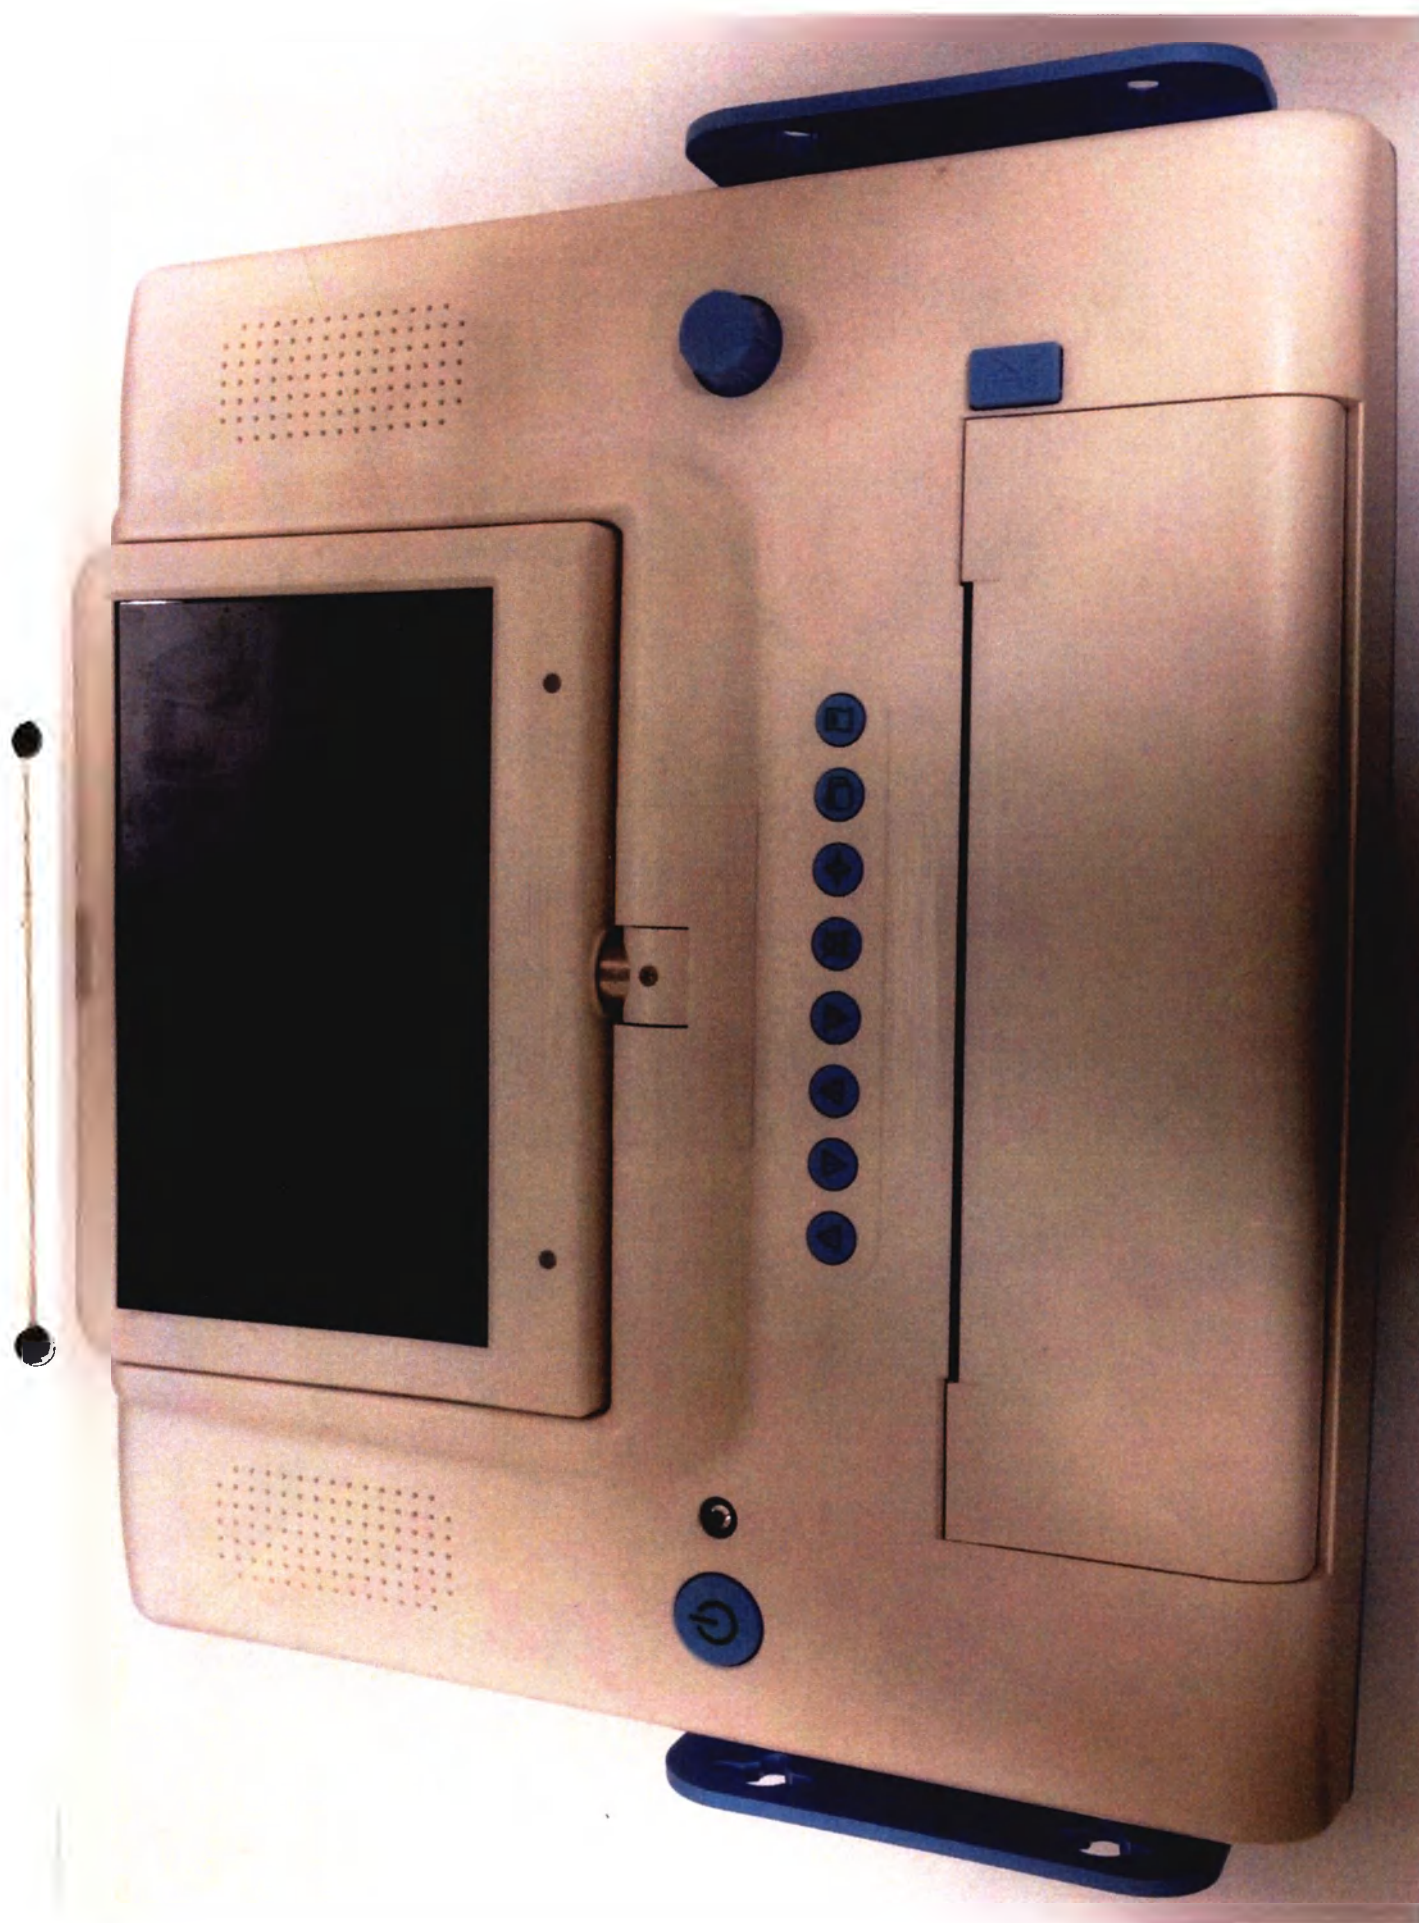

Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями
Внешний блок питания



Монитор фетальный «KRISTI-СМ» с принадлежностями
Гель ультразвуковой

FS152-90-80R-01

FHR 240 bpm

210

180


150

120

90

60

30

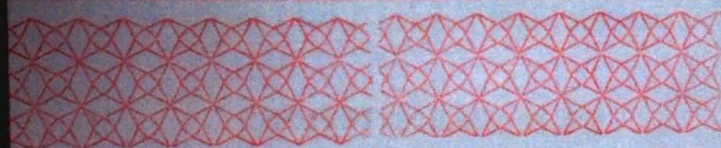

12

10

8

6

4

2

0 kPa

100

75

50

25

UA 0 mmHg

Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями


Лента диаграммная из термобумаги рулонная и складывающаяся для медицинских регистрирующих приборов по ТУ 9398-004-22261422-2009



МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ «KRISTI-CM» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕИМН.941319.001.01 РЭ

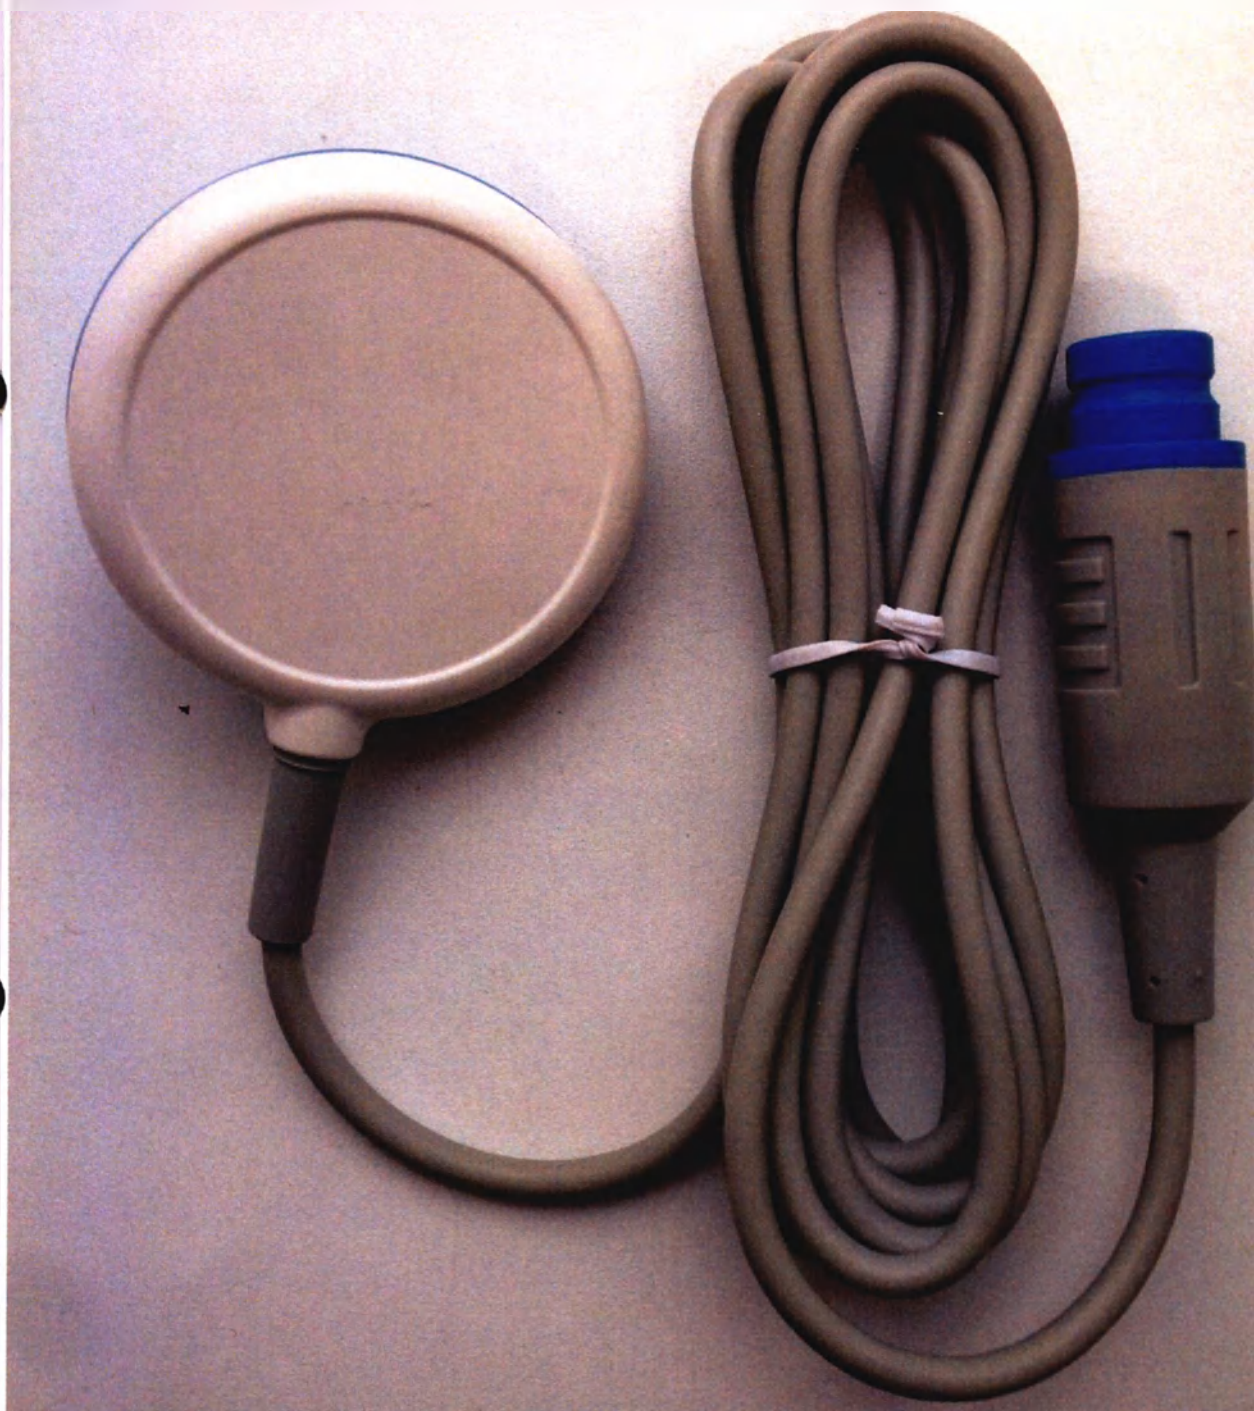


Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями
Датчик ультразвуковой 1,5 МГц



Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями
Голодатчик



Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями
Маркер событий

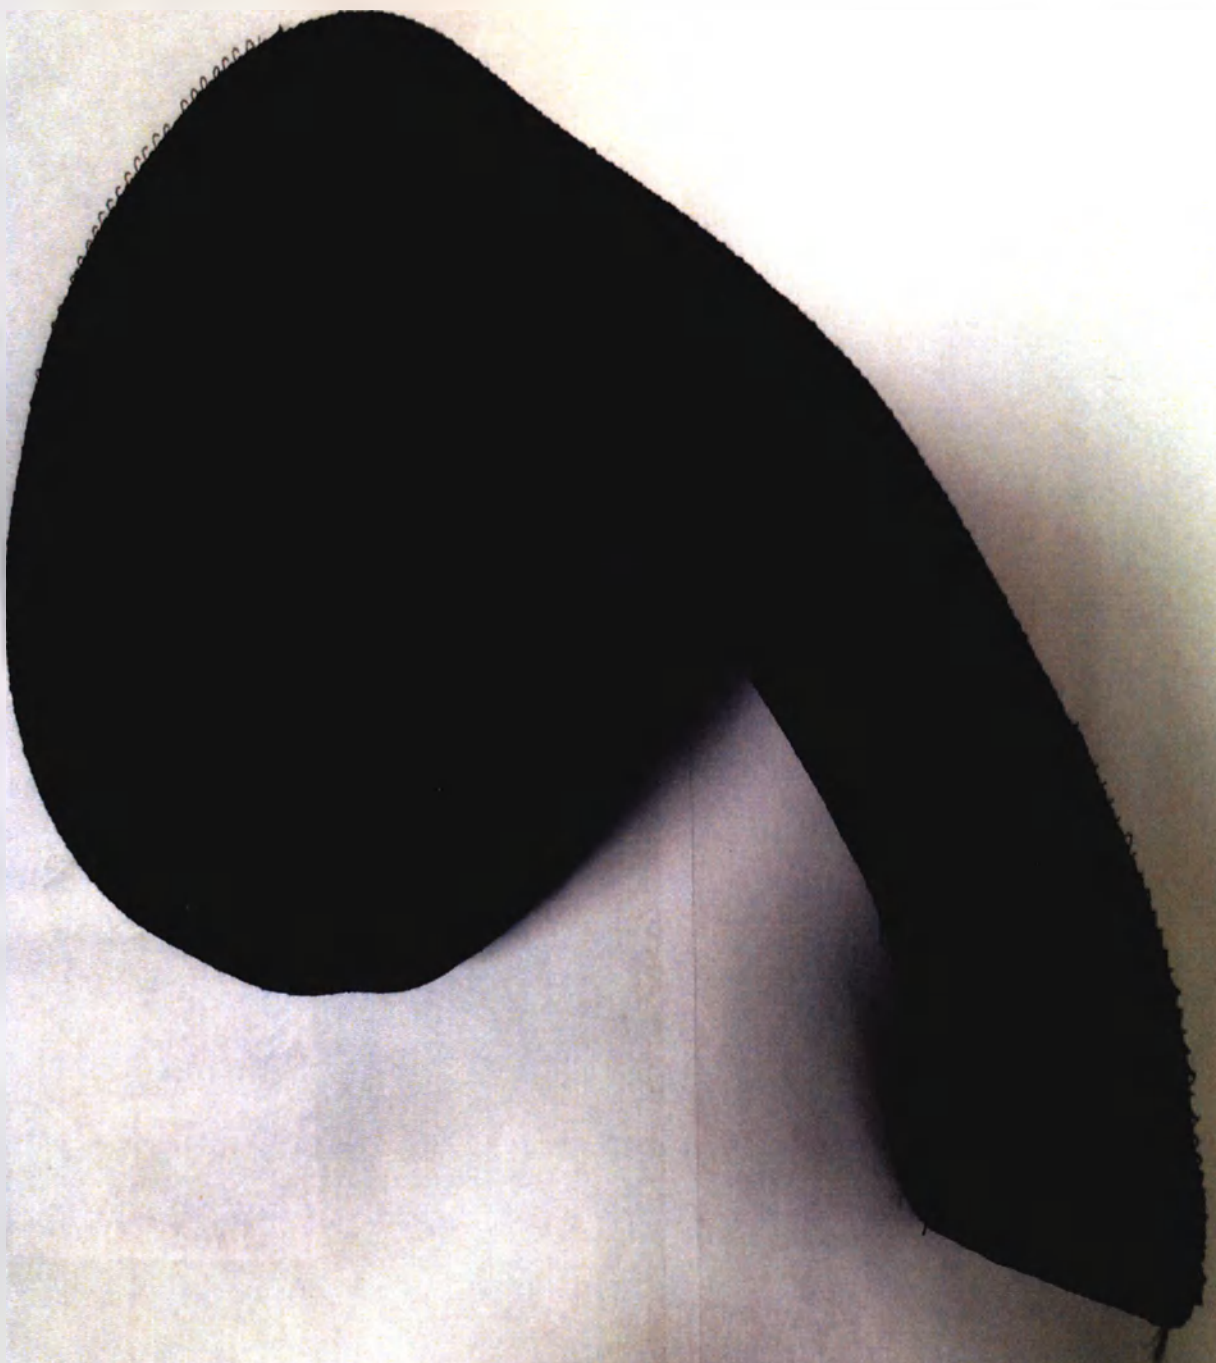

Монитор фетальный «KRISTI-CM» с принадлежностями
Лояс фиксации

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 9 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «УникХелз»

Манохина И.В.

М.П.

2015 года

