

Фотографии медицинского изделия:

«Инструменты стоматологические ротационные для полировки и финишной обработки зубов Полишett одноразовые, в наборах»

производства KENDA AG
Kanalstrasse 18, 9490 Vaduz, Liechtenstein/ Лихтенштейн

1. Фото 1. Набор PS710X.024
2. Фото 2. Маркировка набора PS710X.024
3. Фото 3. Набор PS715X.024
4. Фото 4. Маркировка набора PS715X.024
5. Фото 5. Набор PS716X.024
6. Фото 6. Маркировка набора PS716X.024
7. Фото 7. Набор PS715C.030
8. Фото 8. Маркировка набора PS715C.030
9. Фото 9. Набор PS716C.030
10. Фото 10. Маркировка набора PS716C.030
11. Фото 11. Набор PS715M.030
12. Фото 12. Маркировка набора PS715M.030
13. Фото 13. Набор PS716M.030
14. Фото 14. Маркировка набора PS716M.030
15. Фото 15. Набор PS715F.015
16. Фото 16. Маркировка набора PS715F.015
17. Фото 17. Набор PS716F.015
18. Фото 18. Маркировка набора PS716F.015

Генеральный директор ООО «МедТестКонсалтинг»
(должность)



В. К. Бунзя
(И.О.Фамилия)



Фото 1. Набор PS710X.024. 1. Полир чашевидный с частицами карбида кремния, диаметр 6,5 мм – 5 шт. 2. Полир чашевидный с частицами оксида алюминия, диаметр 6,5 мм – 5 шт. 3 – полир чашевидный с алмазными частицами, диаметр 6,5 мм – 2 шт. 4. Полир копьевидный с частицами карбида кремния, диаметр 3,0 мм – 5 шт. 5. Полир копьевидный частицами оксида алюминия, диаметр 3,0 мм – 5 мм. 6. Полир

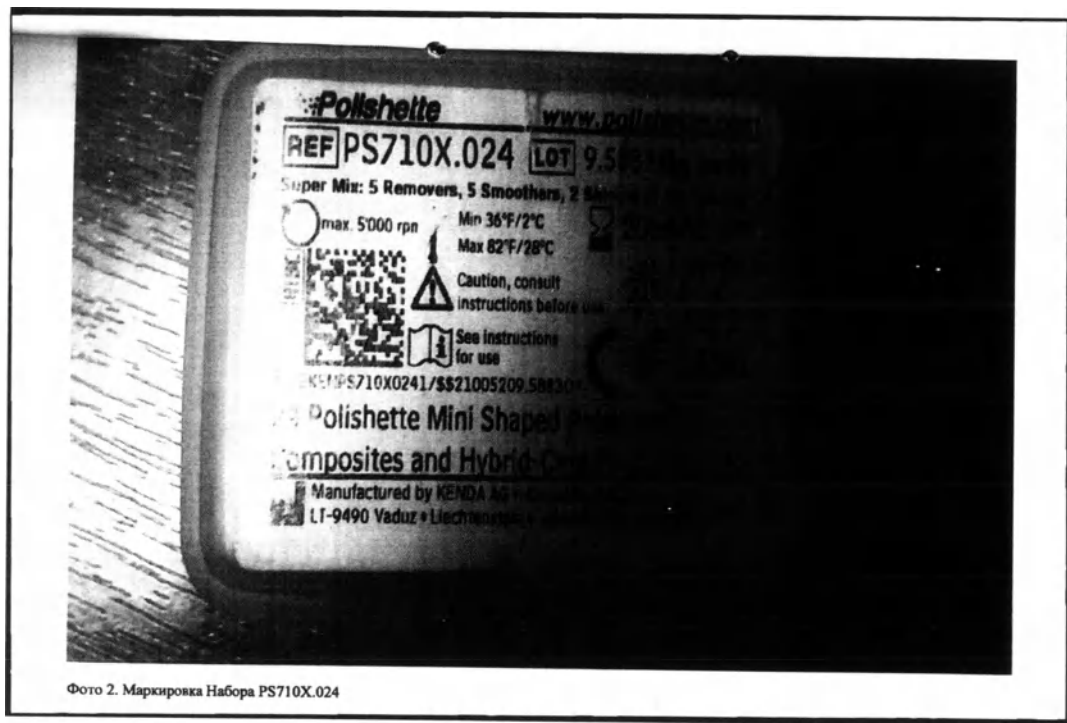


Фото 2. Маркировка Набора PS710X.024



Фото 3. Набор PS715X.024 в составе: полир чашевидный с частицами карбида кремния, диаметр 6,5 мм – 5 шт., полир чашевидный с частицами оксида алюминия, диаметр 6,5 мм – 5 шт., полир чашевидный с алмазными частицами, диаметр 6,5 мм – 2 шт.

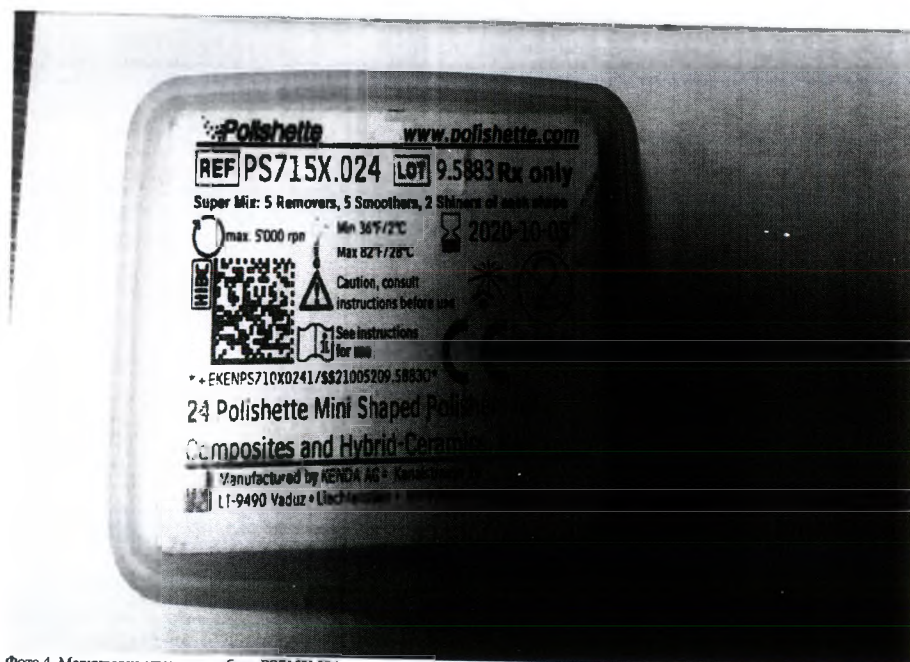


Фото 4. Маркировка упаковки набора PS715X.024

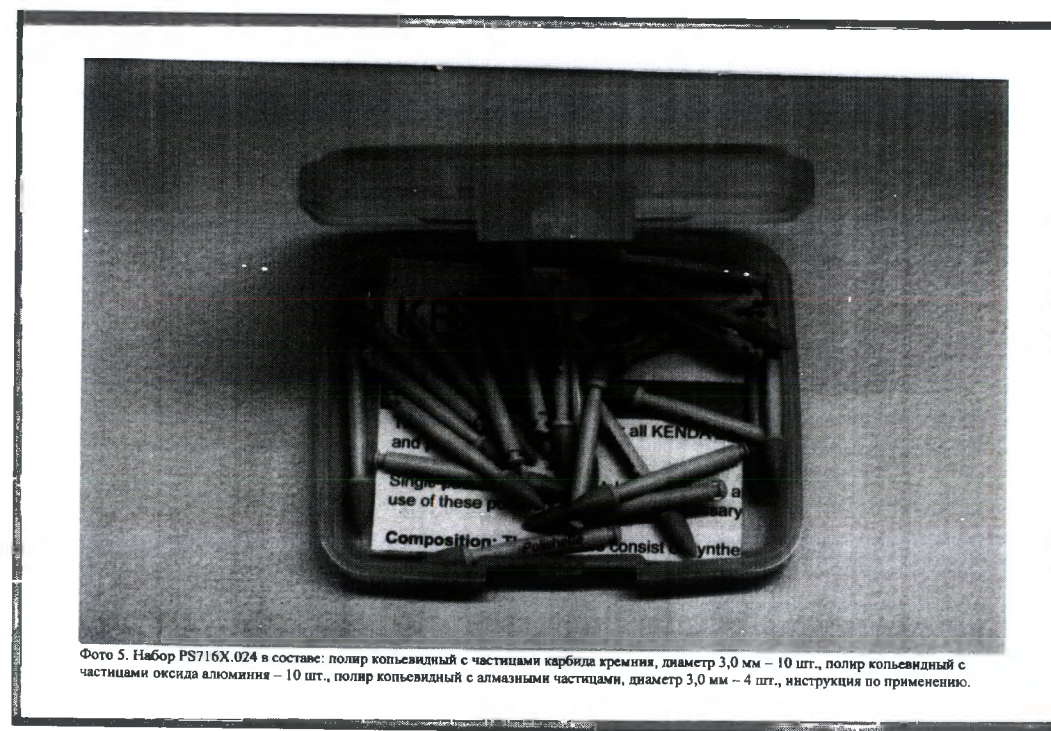


Фото 5. Набор PS716X.024 в составе: полир коьевидный с частицами карбида кремния, диаметр 3,0 мм – 10 шт., полир коьевидный с частицами оксида алюминия – 10 шт., полир коьевидный с алмазными частицами, диаметр 3,0 мм – 4 шт., инструкция по применению.



Фото 6. Маркировка Набор PS716X.024



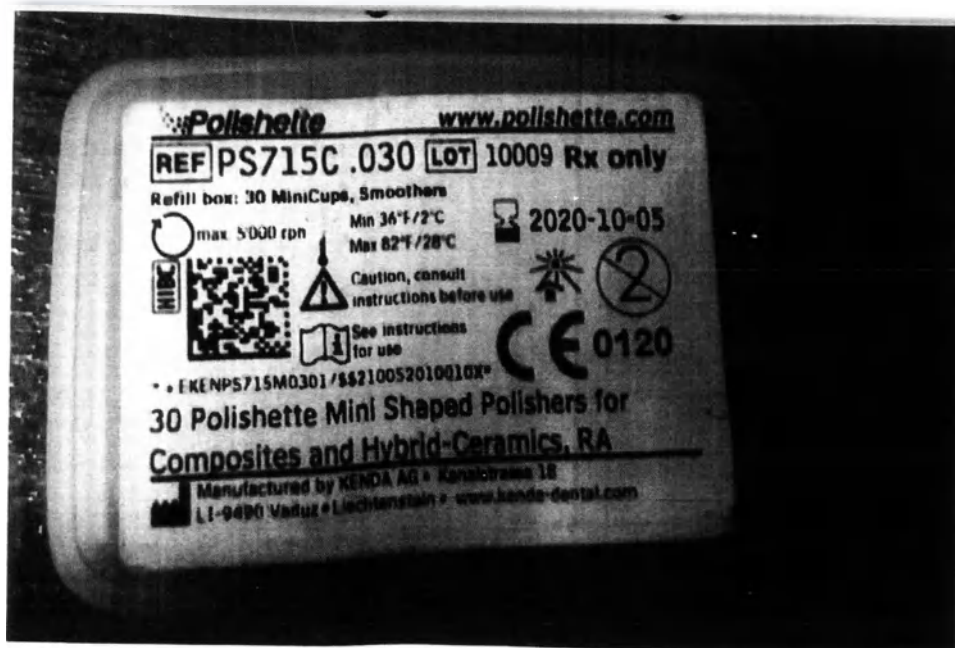


Фото 8. Маркировка Набор PS715C.030



Фото 9. Набор PS716C.030. В составе: полир когевидный с частицами карбида кремния, диаметр 3,0 мм – 30 шт., инструкция по применению.



Фото 10. Маркировка набора Набор PS716C.030.



Фото 11. Набор PS715M.030 в составе: полир чашевидный с частицами оксида алюминия, диаметр 6,5 мм – 30 шт., инструкция по применению.



Фото 12. Маркировка Набор PS715M.030



Фото 13. Набор PS716M.030 в составе: полир коьевидный с частицами оксида алюминия, диаметр 3,0 мм – 30 шт., инструкция по применению.

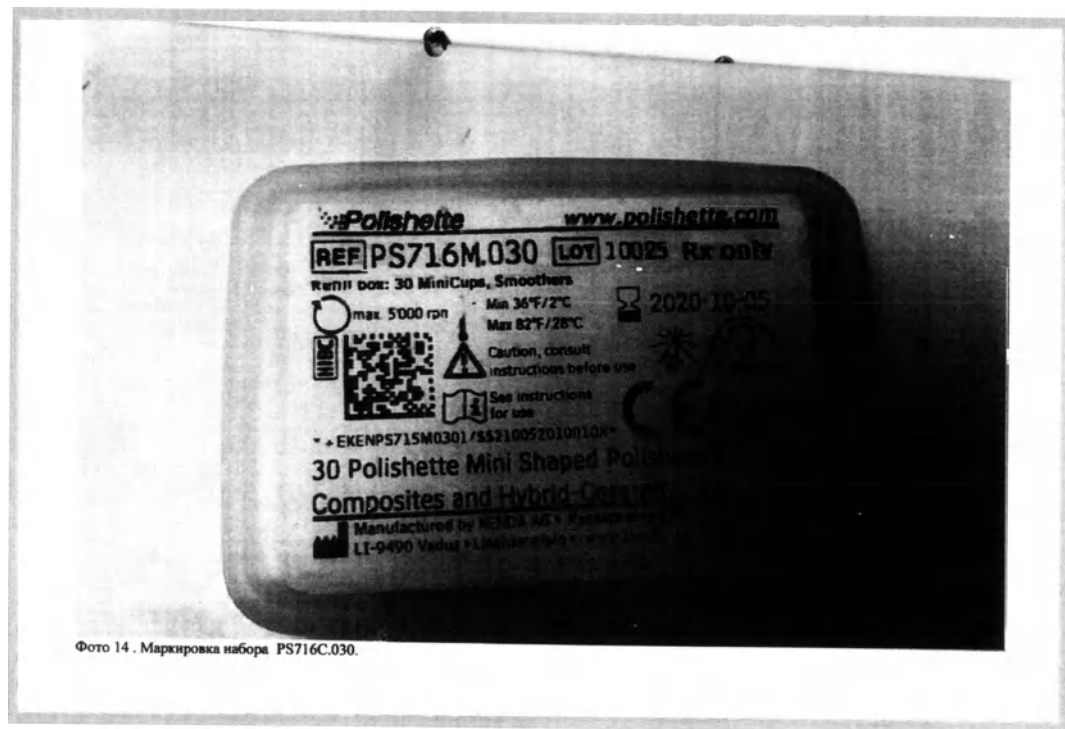


Фото 14. Маркировка набора PS716C.030.



Фото 16. Магнитовая Набор PS715F.015



Фото 17. Набор PS716F.015 в упаковке: набор аппликаторов с внешними частями, диаметр 3,0 мм – 15 шт., инструкция по применению.

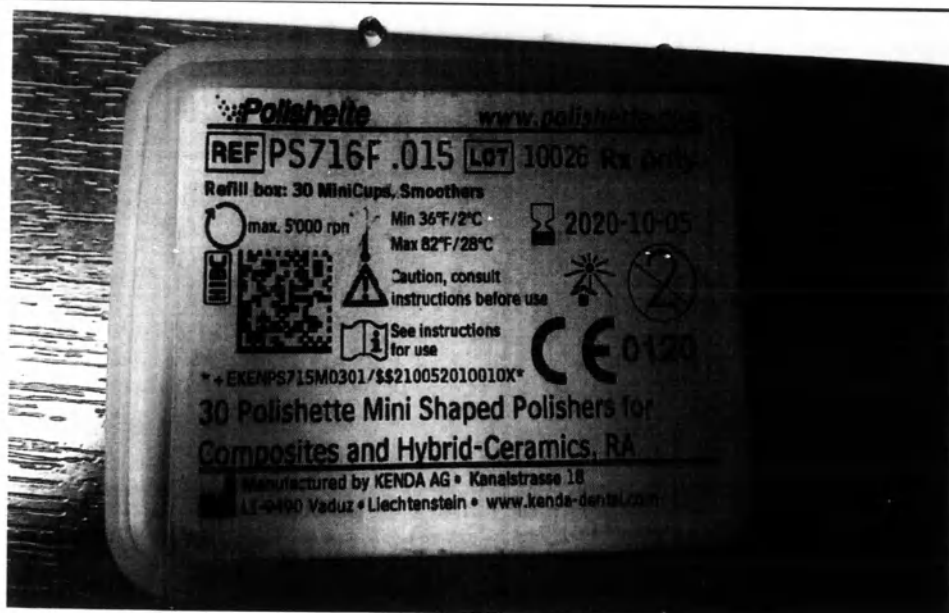


Фото 18. Внешний вид медицинского изделия в индивидуальной упаковке с маркировкой. 1. Набор PS710X.024/ 2. Набор PS715M/030/

19 И
Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
лист(ов) Генеральный директор
ООО "МедТестКонсалтинг"
В.К. Булгаков

