

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Меса Групп»



Горбунова Д.Н.
2020 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

Аппарат медицинский косметологический для лечения поверх-ностных дефектов
кожи плазмой Plexr

Производитель:
GMV S.r.l. (ДжиЭмВи С.р.л.)
Юридический адрес и оперативная штаб-квартира:
Via Roberto Paribeni 37, 00173 Roma, Italy
(Виа Роберто Парибени 37, 00173 Рим, Италия)

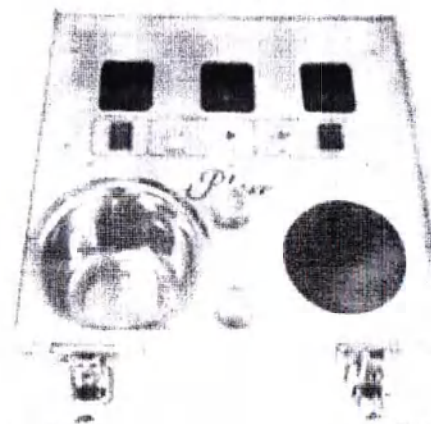


Фото 1. Основная док-станция Plexr Cubo.

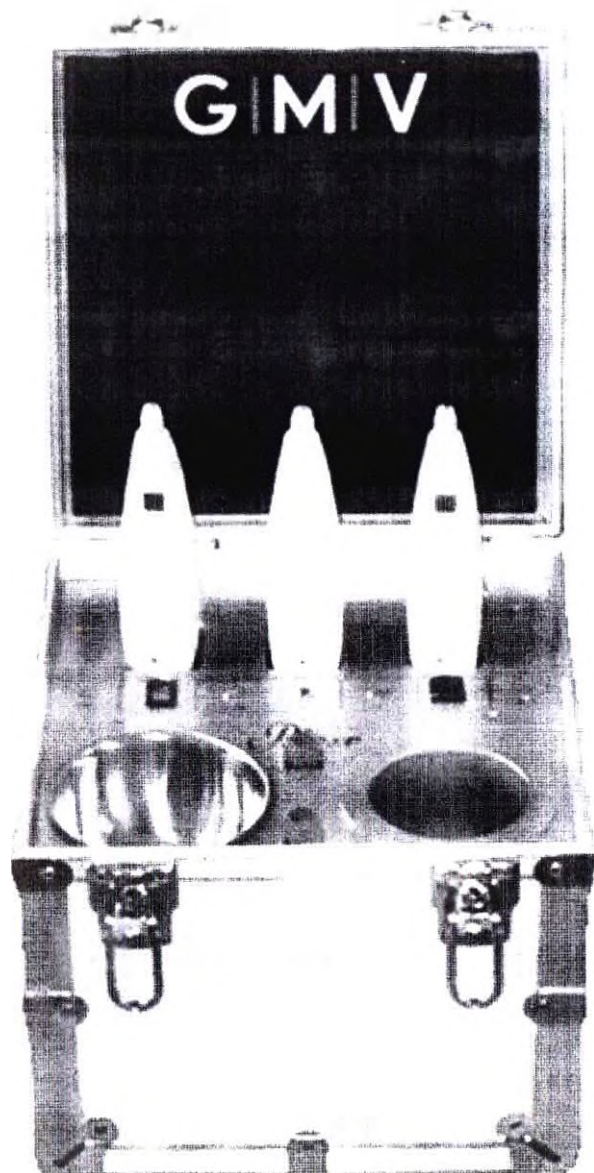


Фото 2. Основная док-станция Plexig Sibio в рабочем положении

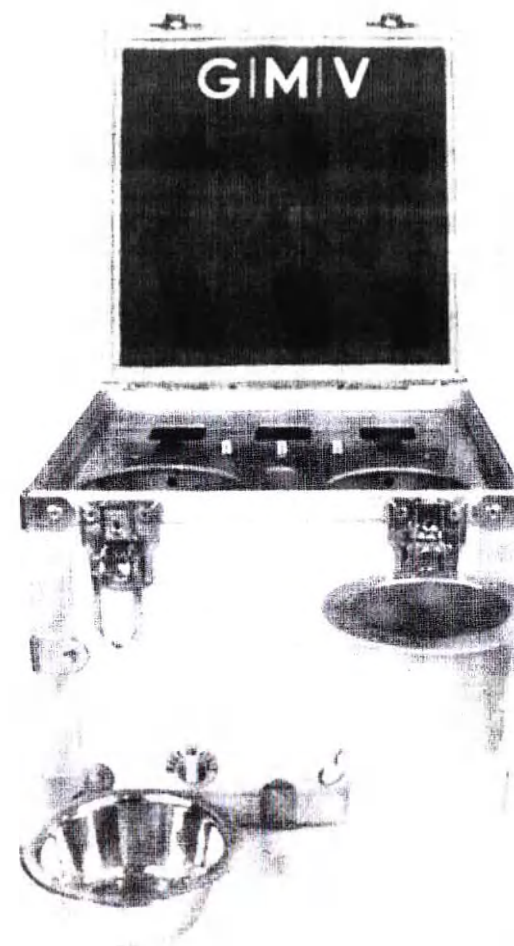


Фото 3. Основная док-станция Plexig Sibio с лотком круглым и стаканом-подставкой.

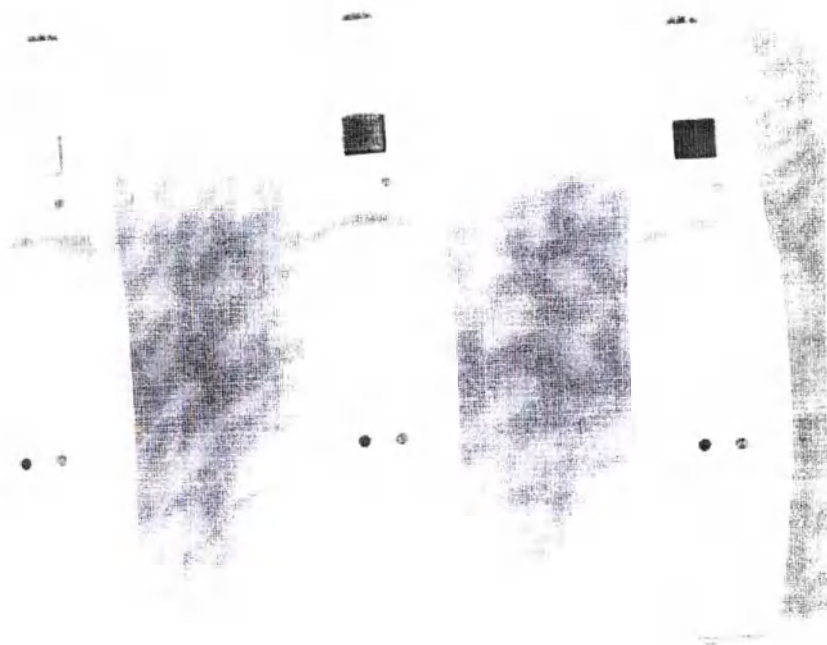


Фото 4.

- манипула Plexr Cubo L на фото слева
- манипула Plexr Cubo M на фото посредине
- манипула Plexr Cubo H на фото справа



Фото 5. Сумка для принадлежностей Plexr Cubo и Plexr Plus



Фото 6. Блок питания мобильного блока зарядки Meapwell модель GSM60A15-P1J с сетевым шнуром

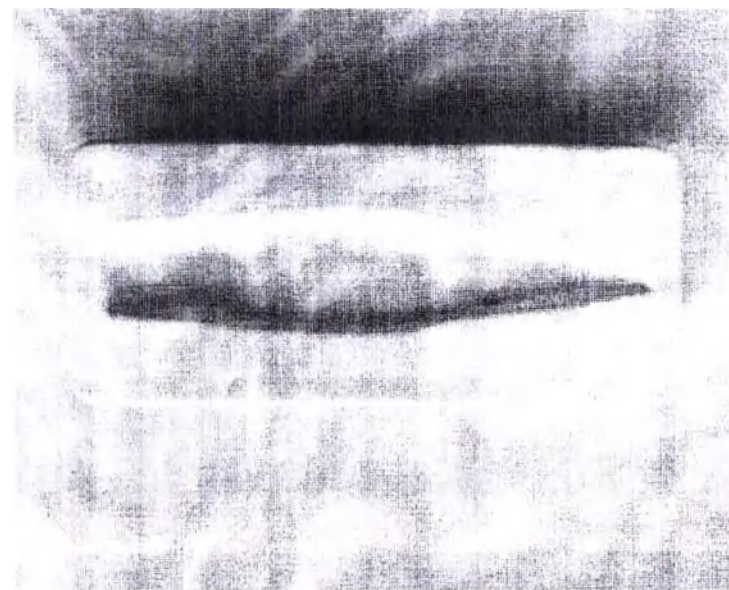


Фото 7. Мобильный блок зарядки.
 - вид сверху фото сверху
 - вид со стороны разъема для зарядного устройства фото снизу

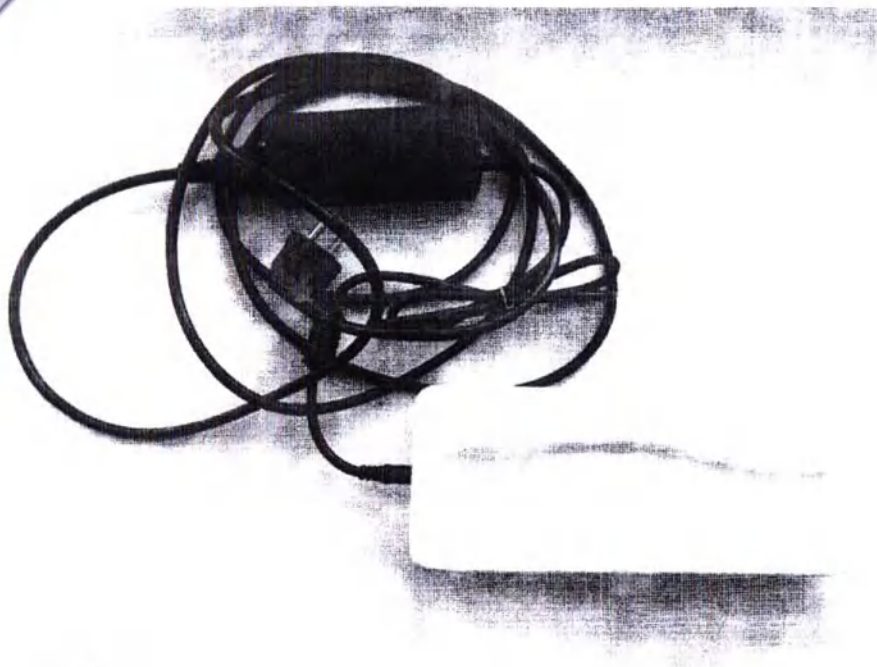


Фото 8. Мобильный блок зарядки с блоком питания мобильного блока зарядки Meanwell модель GSM60A15-PIJ с сетевым шнуром

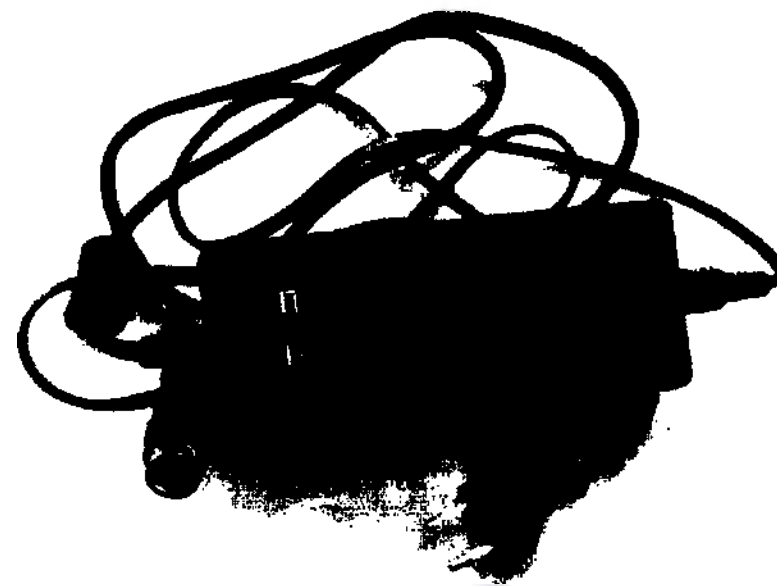


Фото 9. Блок питания Meanwell Модель GSM160B24-R7B с сетевым шнуром

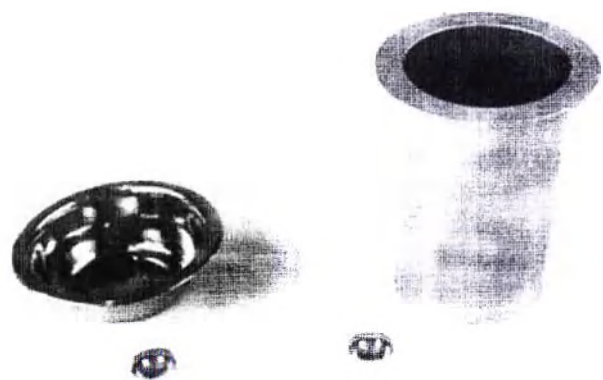


Фото 10 . Дюжок круглый, стакан – подставка, футляры для электродов –
 аппликаторов

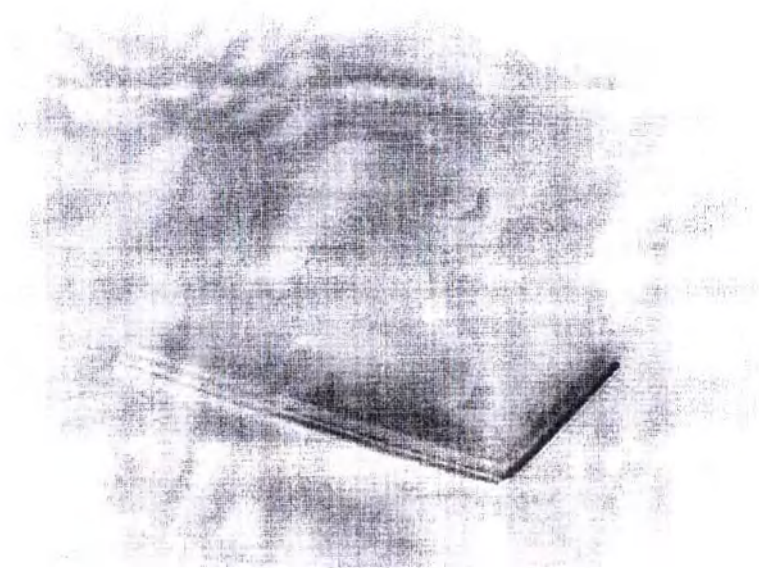


Фото 11 . Электрод – игла в защитном колпачке

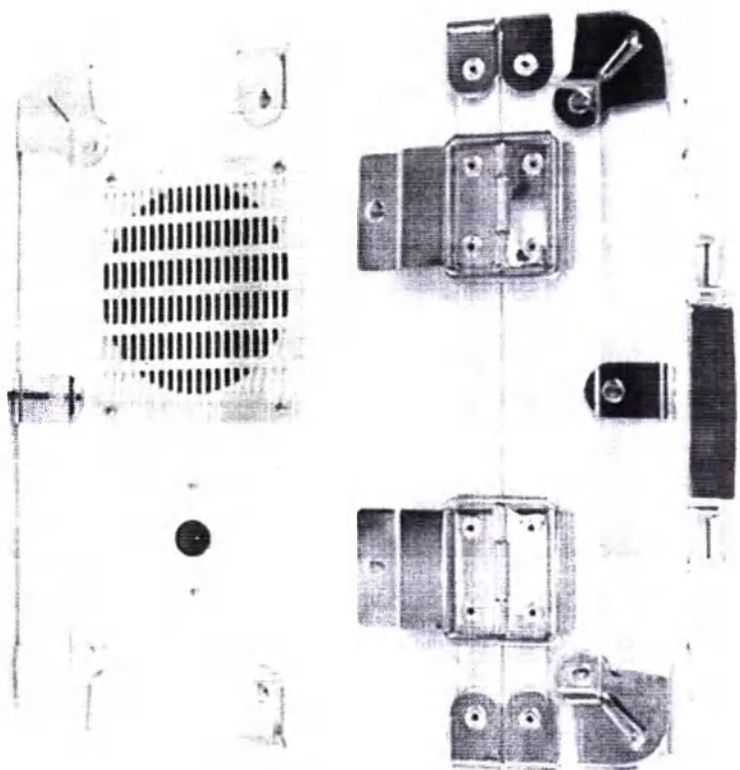


Фото 12. Вид задней панели Plexr Cubo.



Фото 13. Вид боковой панели Plexr Cubo с маркировочной табличкой.

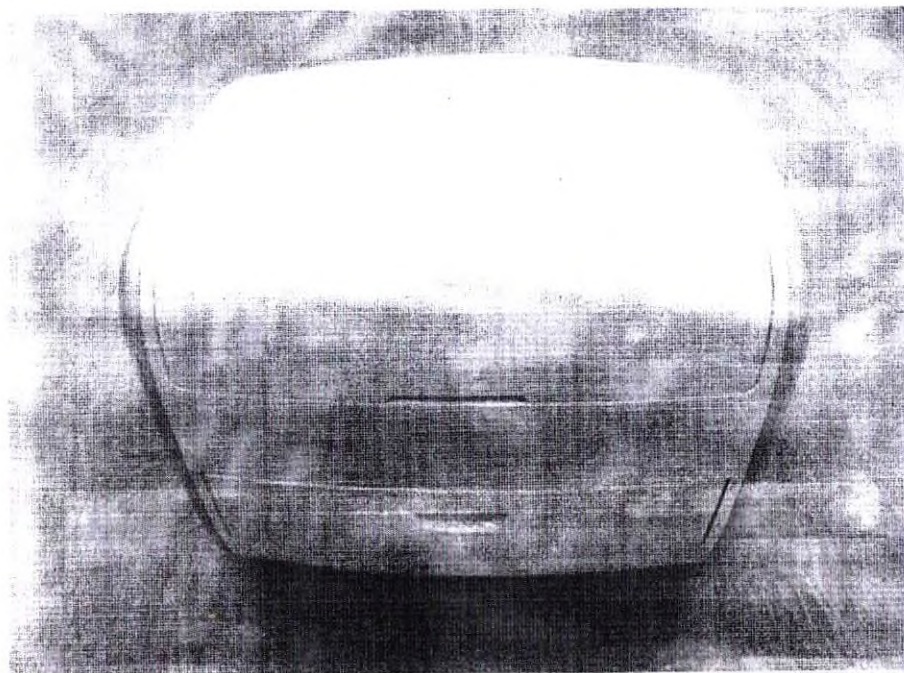


Фото 14. Основная док-станция Plexr Plus

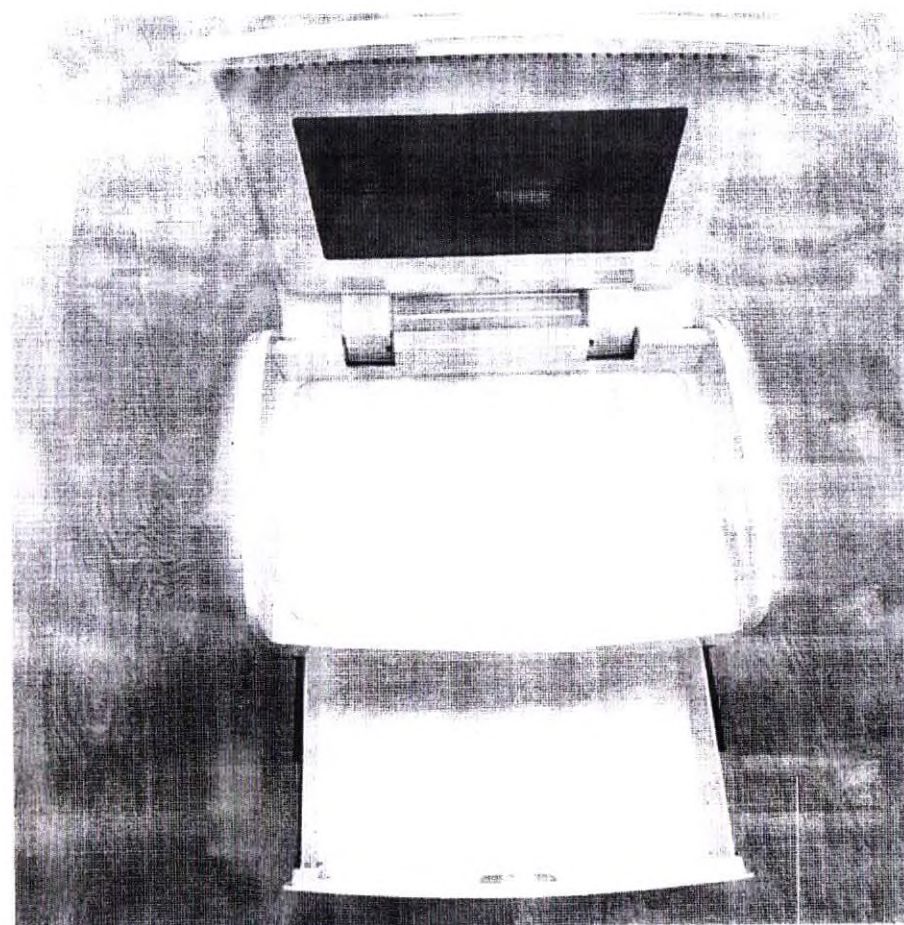


Фото 15. Основная док-станция Plexr Plus

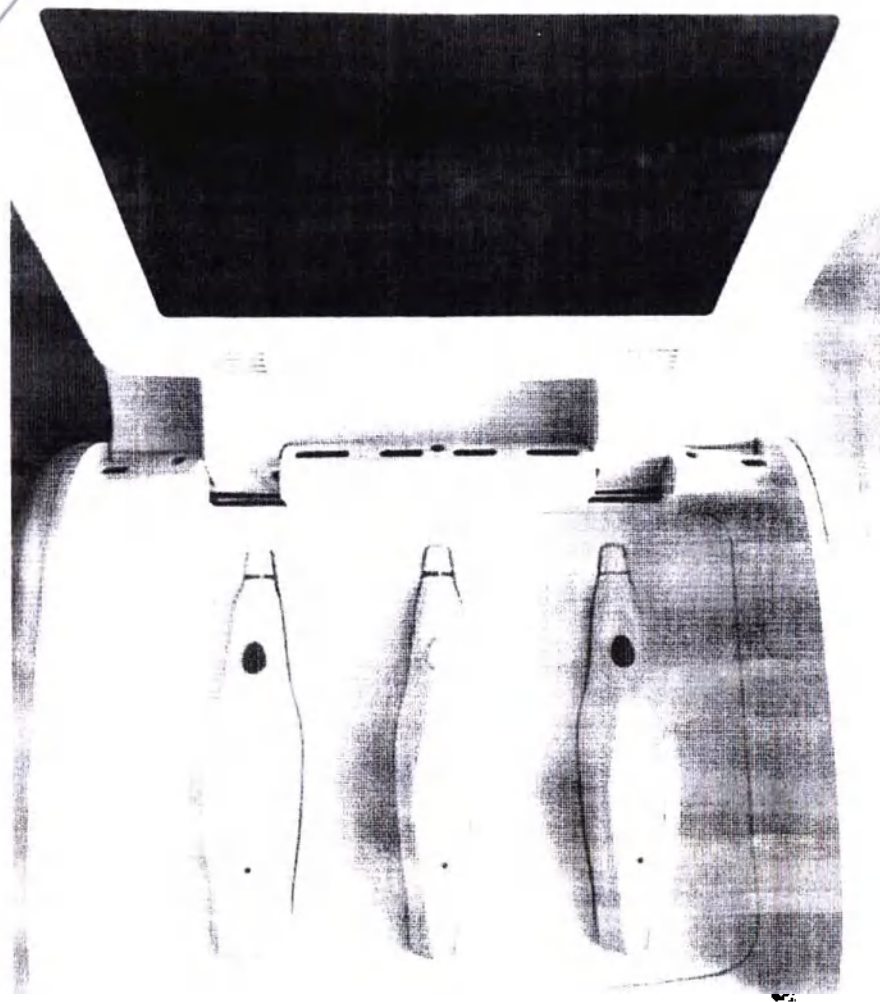


Фото 16. Основная док-станция Plexr Plus

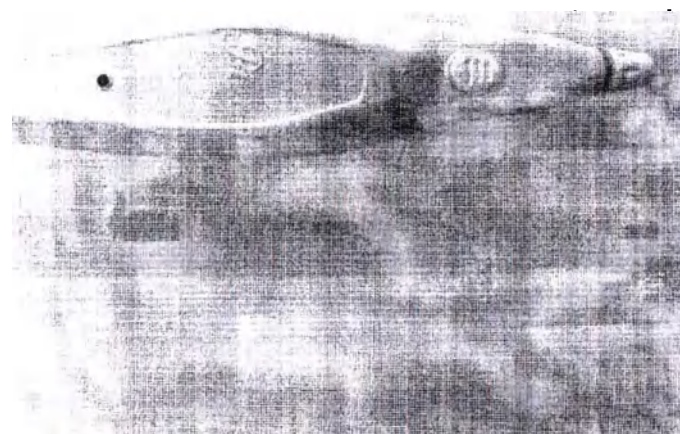


Фото 17. Манипула Plexr Plus L

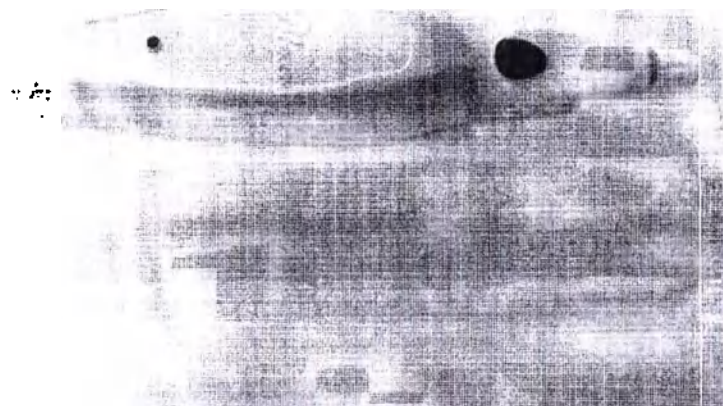


Фото 18. Манипула Plexr Plus M

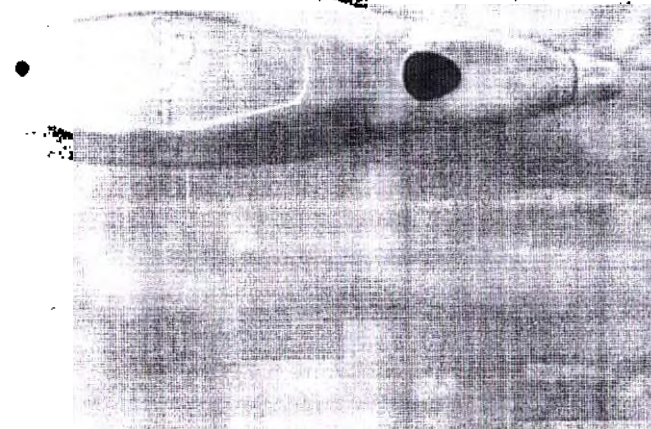


Фото 19. Манипула Plexr Plus H

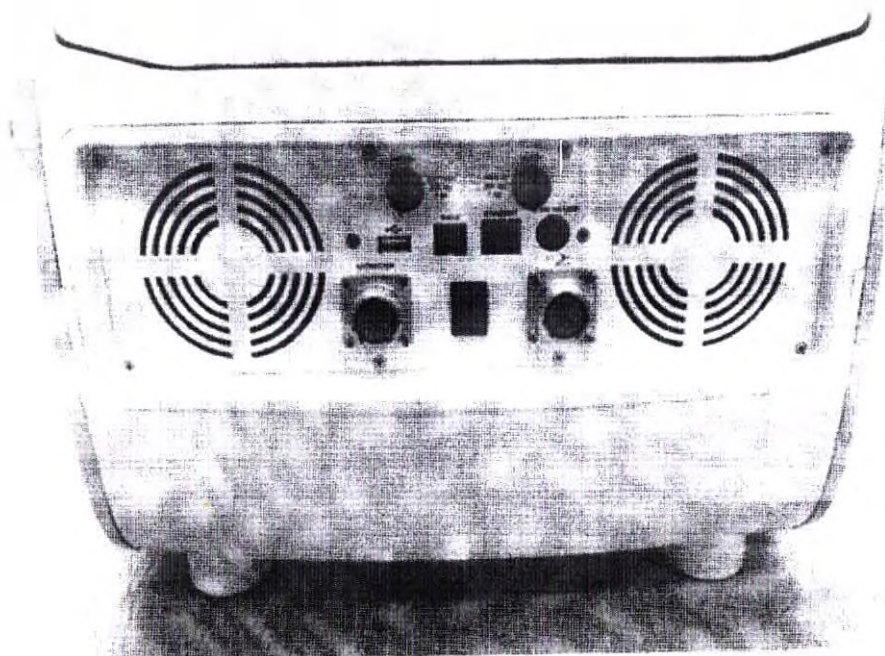


Фото 20. Вид задней панели Plexr Plus.

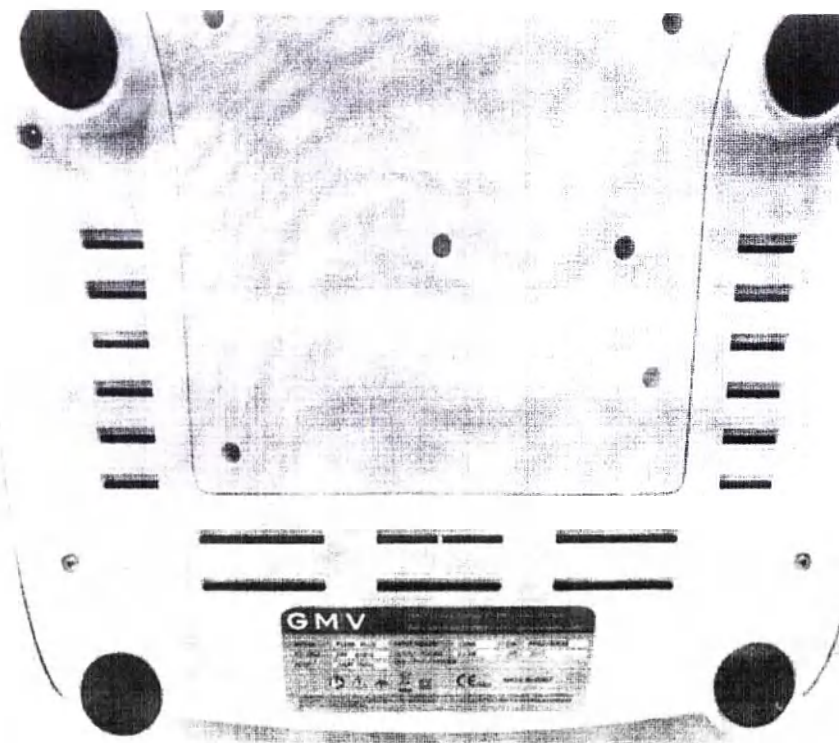


Фото 21. Вид нижней панели Plexr Plus с маркировочной табличкой.

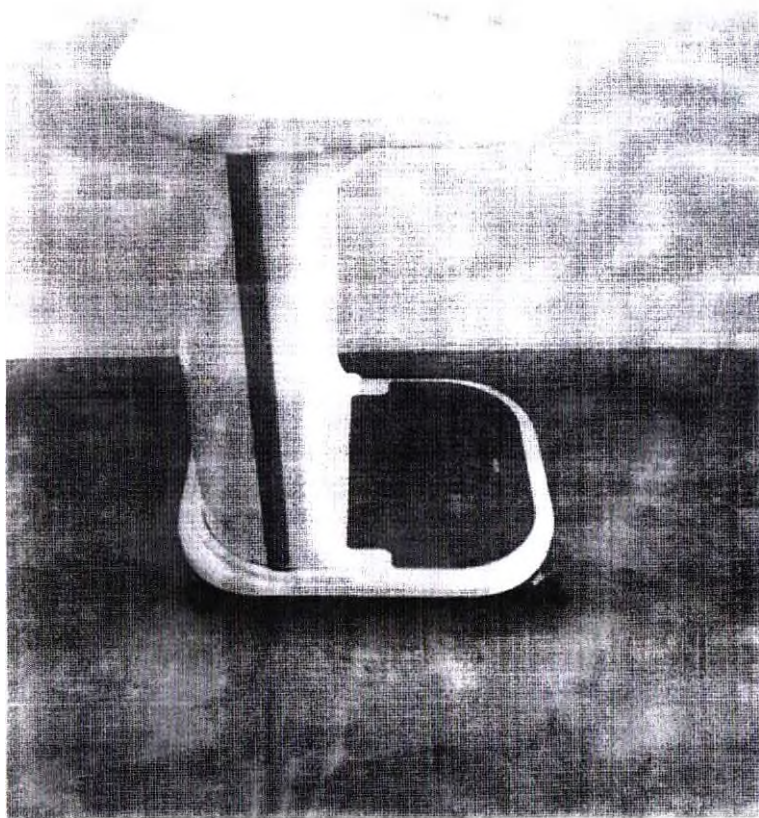


Фото 22. Тележка – подставка



Фото 23. Маркировка упаковки иглы-электрода.


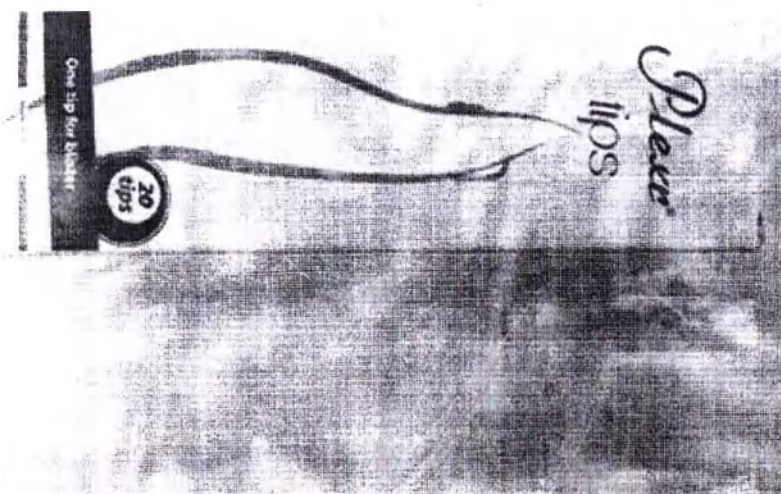


Фото 26. Упаковка иглы-электрода.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Меса Групп»

 Горбунова Д.Н.
« 19 » август 2021 г.



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

Аппарат медицинский косметологический для лечения поверхностных дефектов
кожи плазмой Plexr Plus с принадлежностями

Производитель:
GMV S.r.l. (ДжиЭмВи С.р.л.)
Юридический адрес и оперативная штаб-квартира:
Via Roberto Paribeni 37, 00173 Roma, Italy
(Виа Роберто Парибени 37, 00173 Рим, Италия)


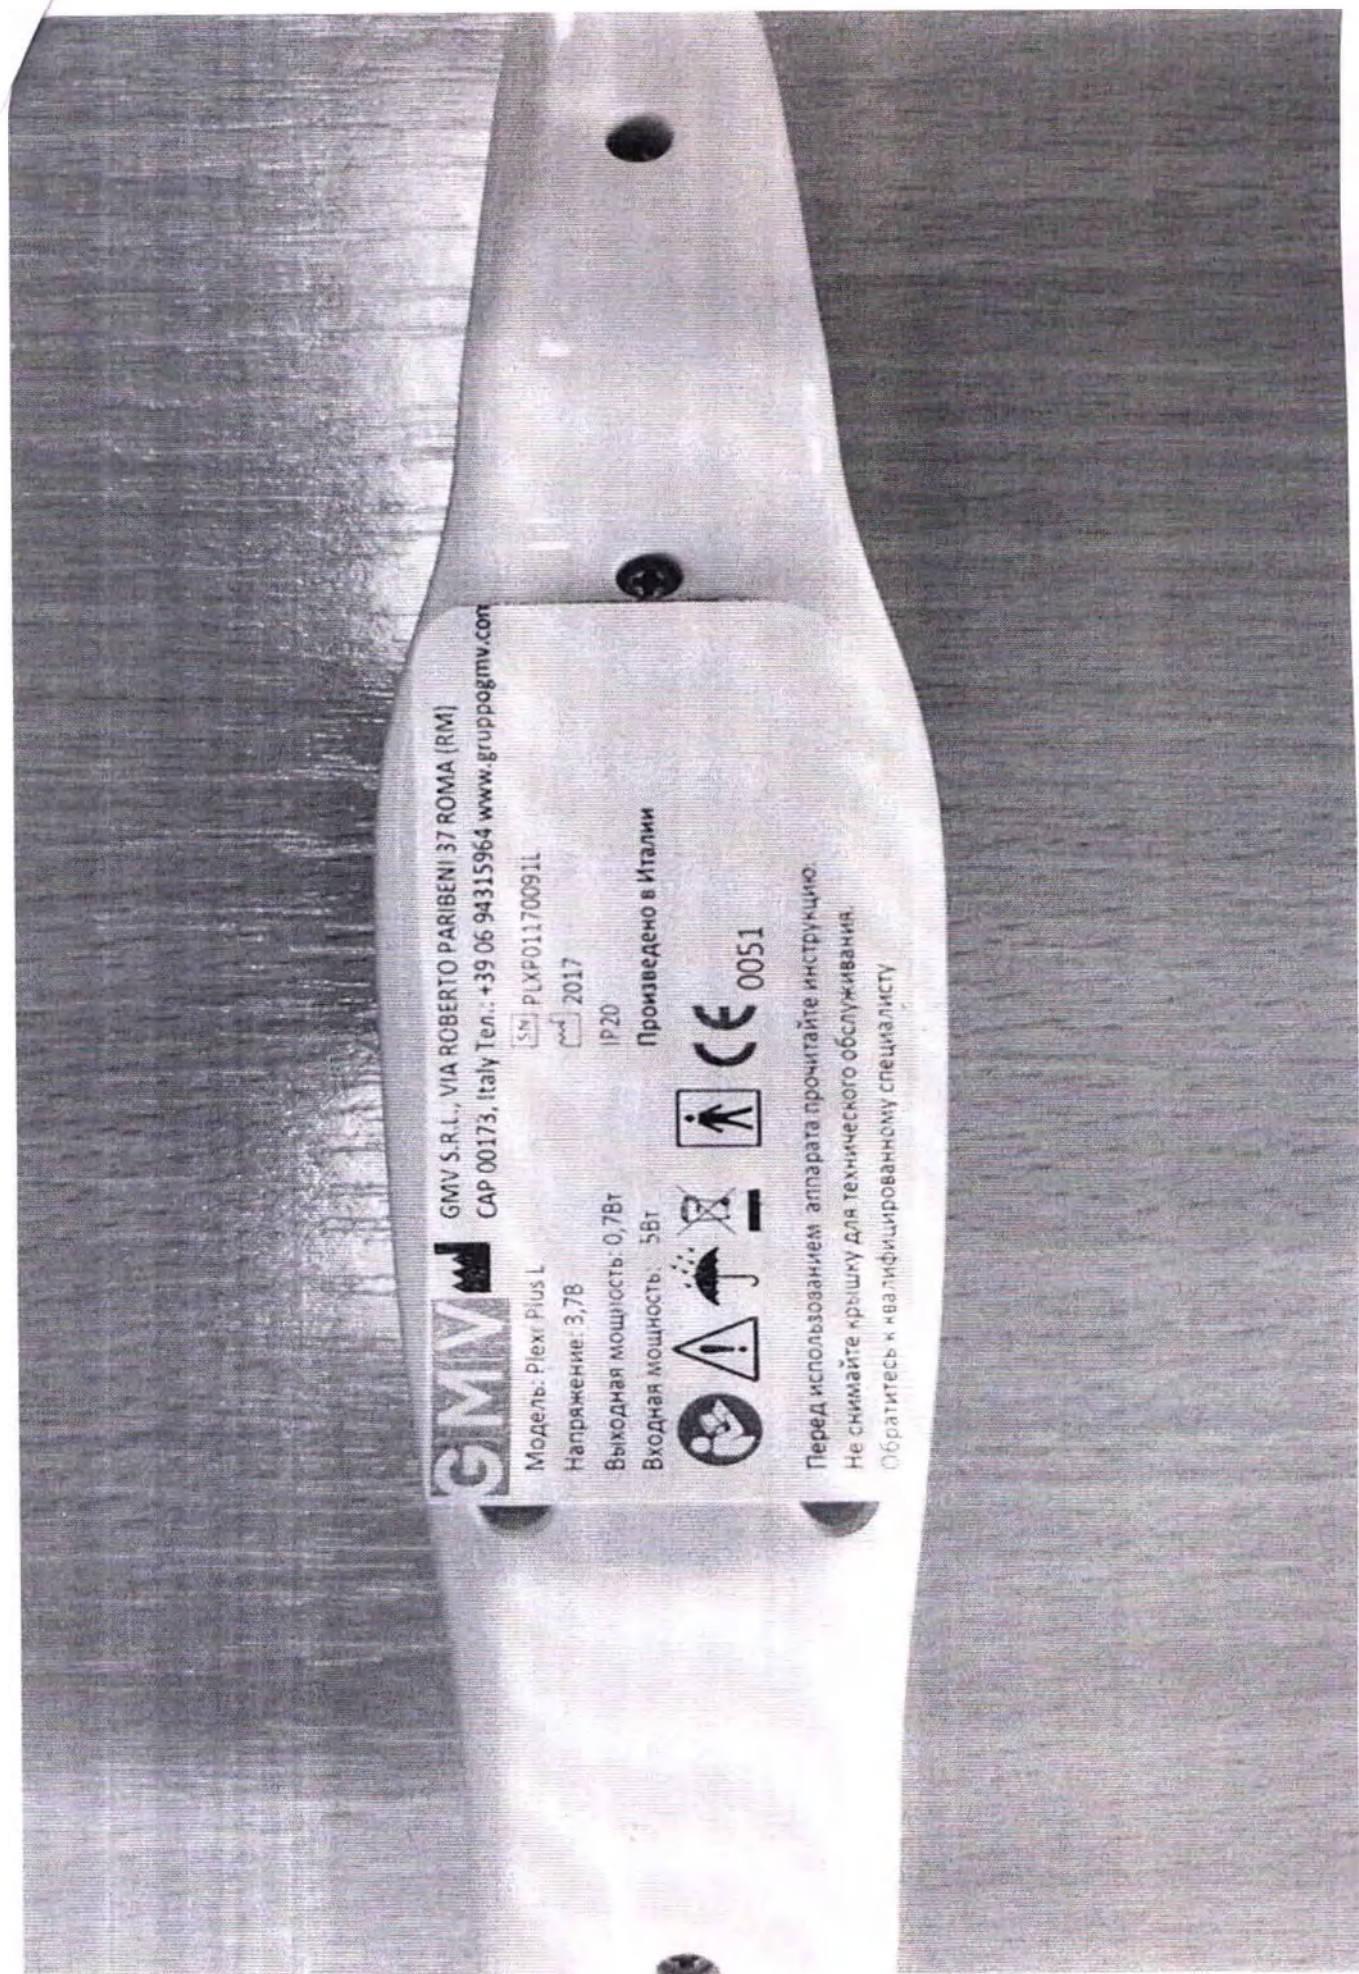


Фото 1. Манипула Plexr Plus L. Маркировка

Фото 2. Манипула Plexr Plus M. Маркировка



GMV

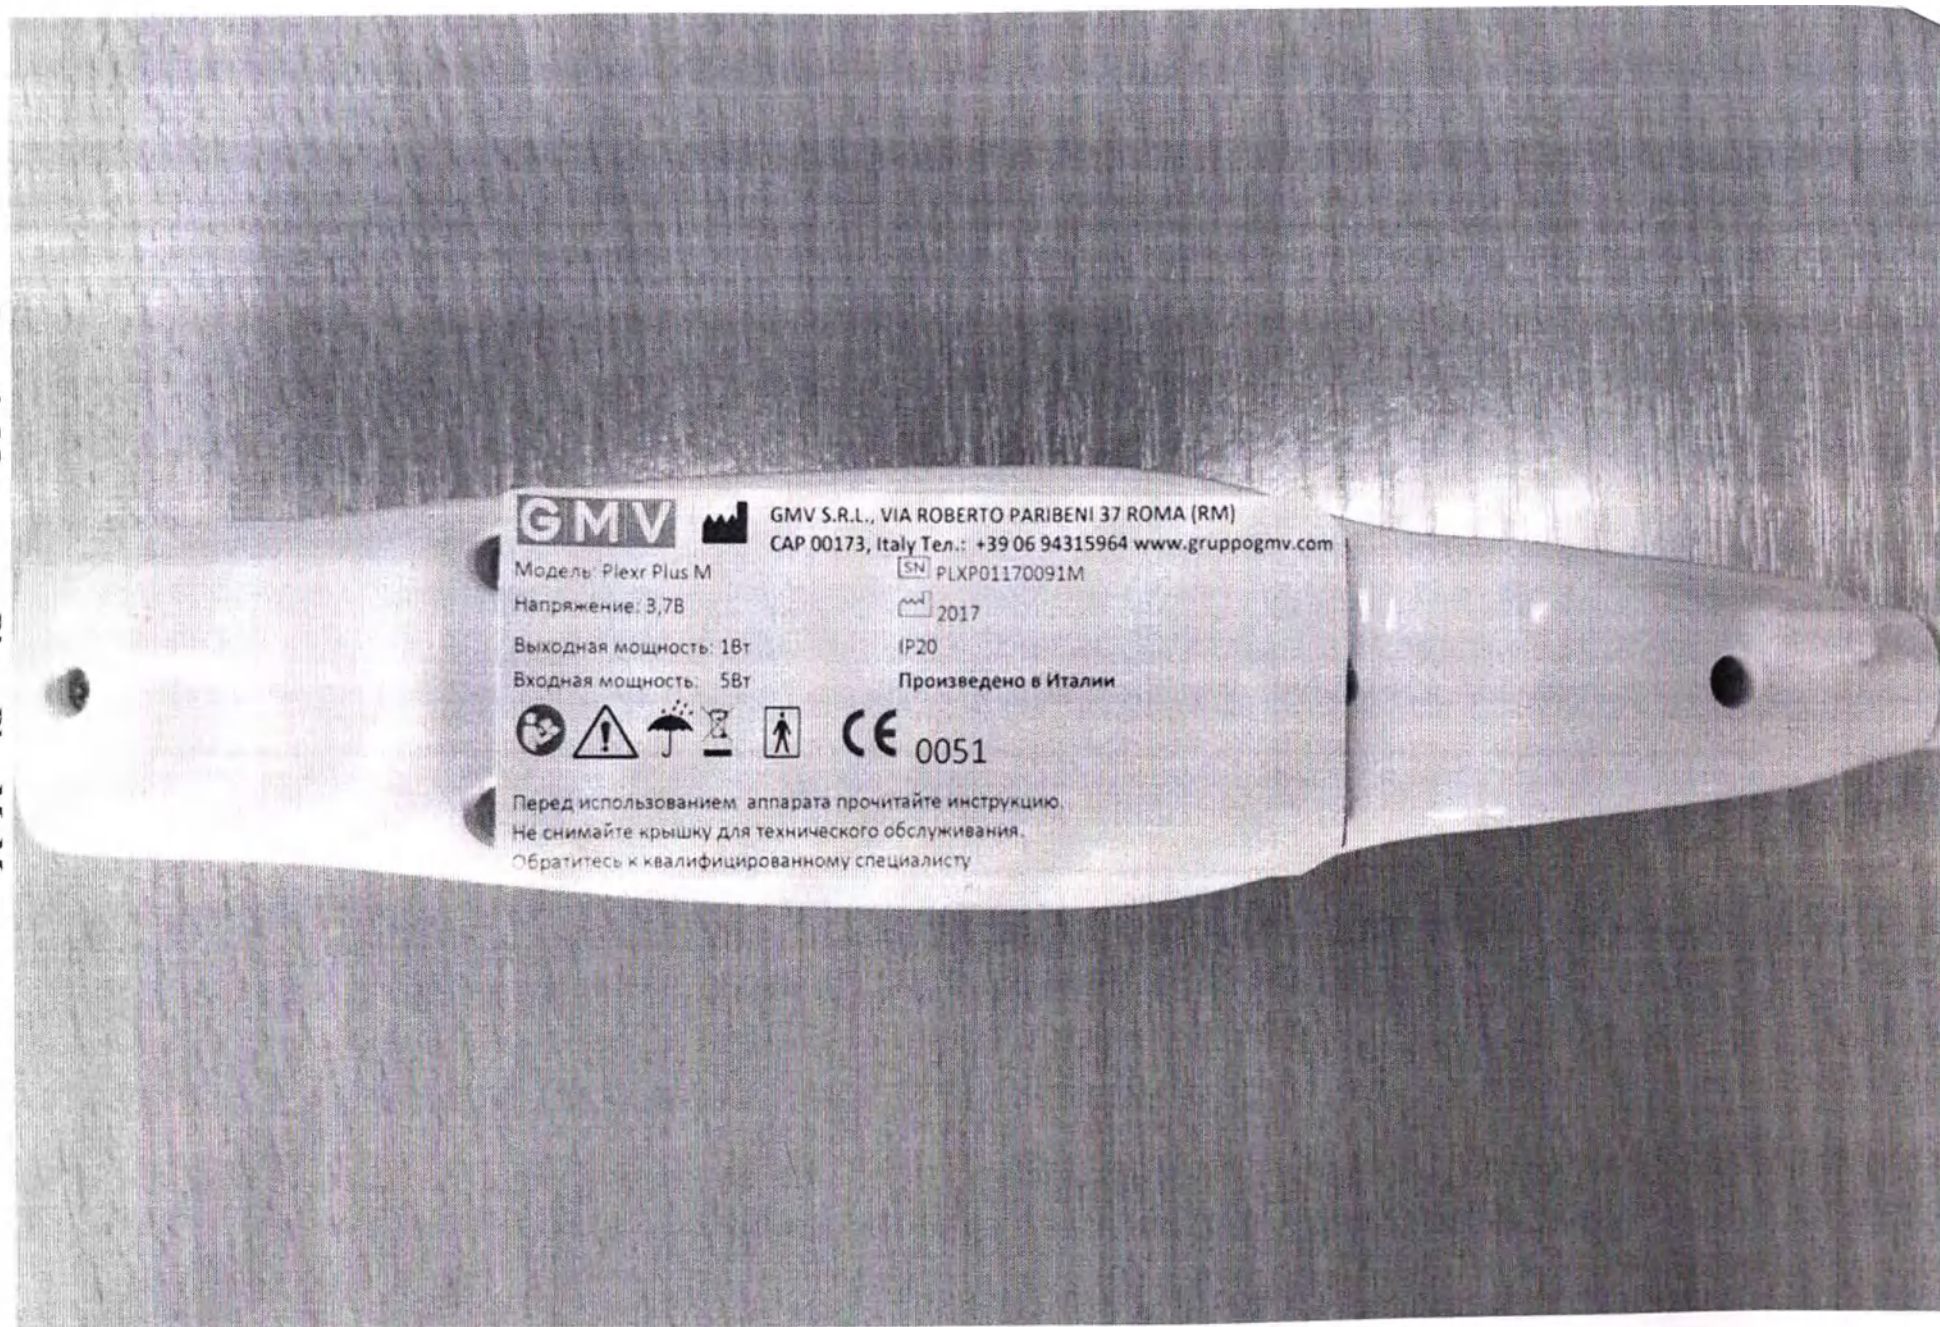

GMV S.R.L., VIA ROBERTO PARIBENI 37 ROMA (RM)
CAP 00173, Italy Tel.: +39 06 94315964 www.gruppogmv.com

Модель: Plexr Plus M

SN PLXP01170091M

Напряжение: 3,7В

2017

Выходная мощность: 18Вт

IP20

Входная мощность: 58Вт

Произведено в Италии



CE 0051

Перед использованием аппарата прочитайте инструкцию.

Не снимайте крышку для технического обслуживания.

Обратитесь к квалифицированному специалисту

Фото 3. Манипула Plexr Plus H. Маркировка

GMV



GMV S.R.L., VIA ROBERTO PARIBENI 37 ROMA (RM)
CAP 00173, Italy Tel.: +39 06 94315964 www.gruppogmv.com

Модель: Plexr Plus H

SN PLXP01170091H

Напряжение: 3,7В

2017

Выходная мощность: 2Вт

IP20

Входная мощность: 5Вт

Произведено в Италии




0051

Перед использованием аппарата прочитайте инструкцию.
Не снимайте крышку для технического обслуживания.
Обратитесь к квалифицированному специалисту



Фото 4. Блок питания мобильного блока зарядки Meanwell модель GSM60A15-P1J. Маркировка

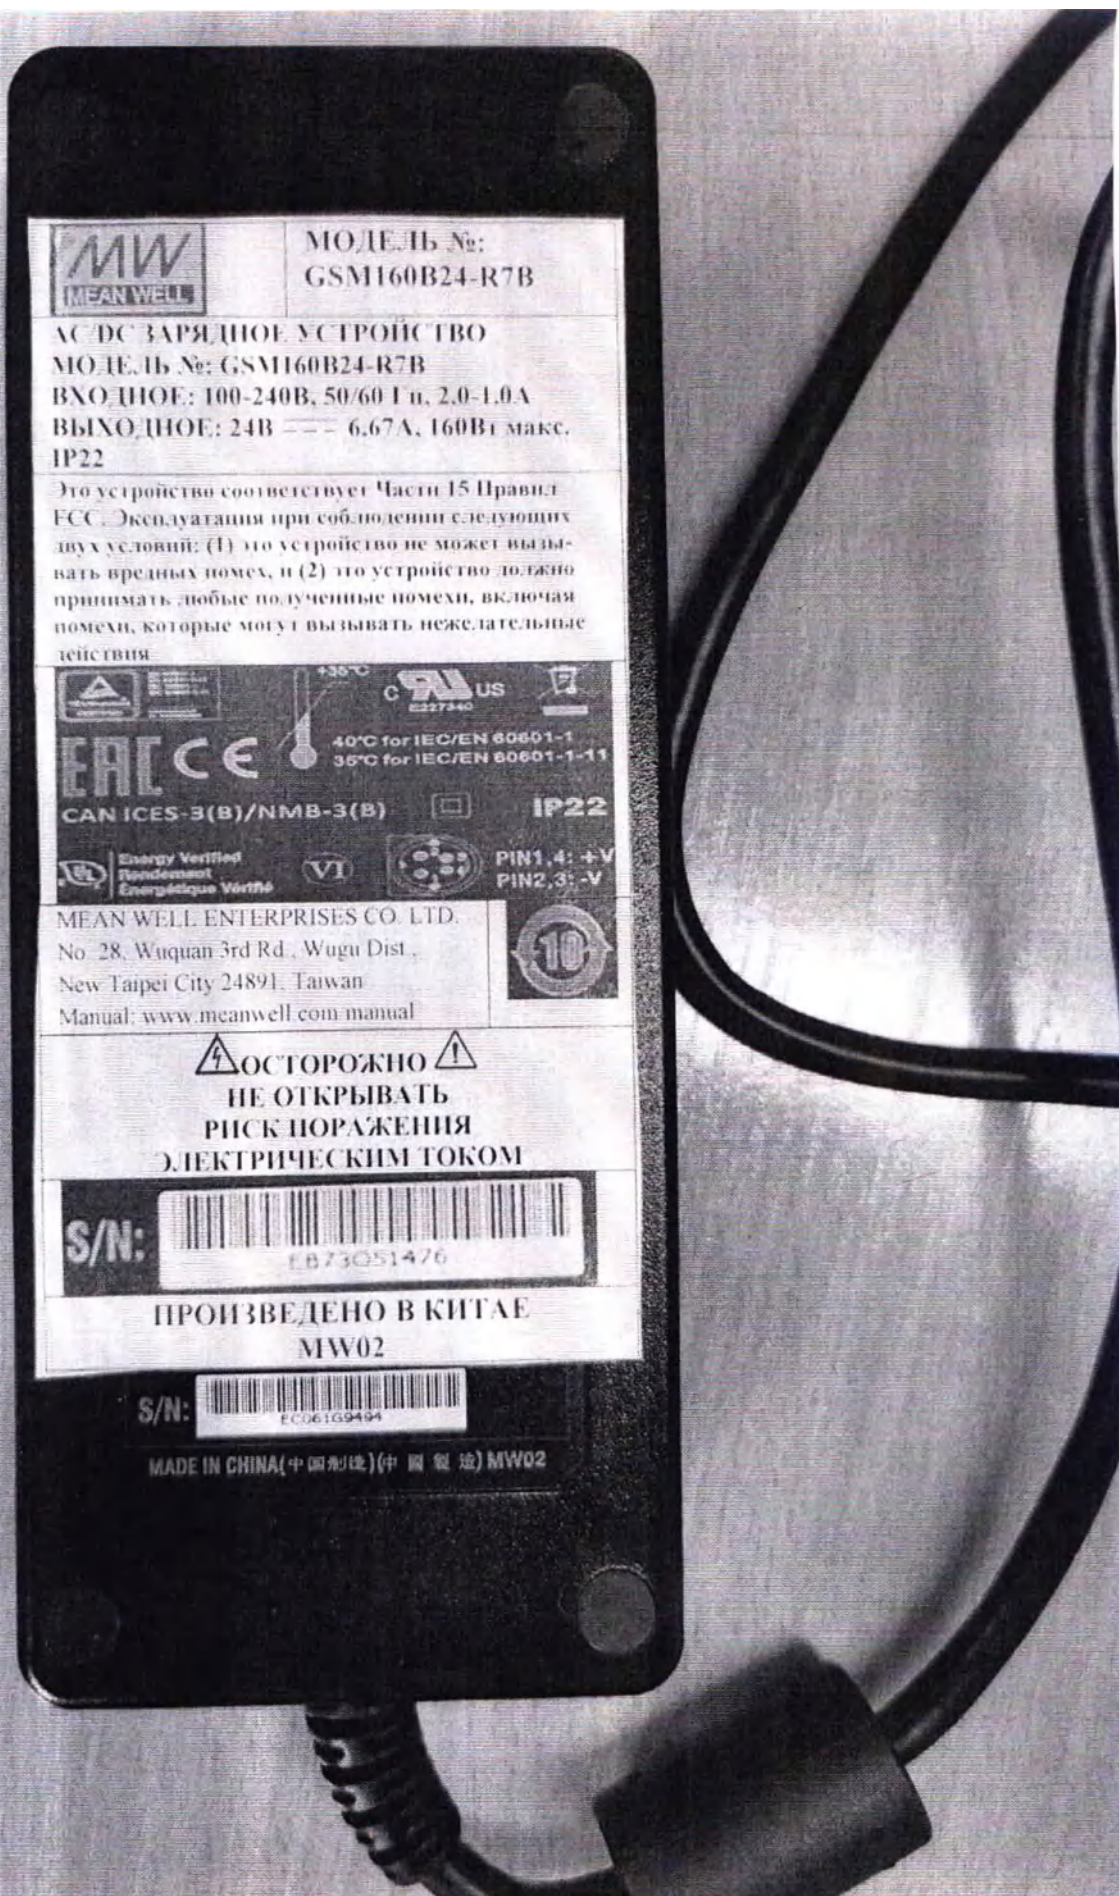

МОДЕЛЬ №:
GSM160B24-R7B

АС/DC ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

МОДЕЛЬ №: GSM160B24-R7B

ВХОДНОЕ: 100-240В, 50/60 Гц, 2.0-1.0А

ВЫХОДНОЕ: 24В --- 6.67А, 160Вт макс.
IP22

Это устройство соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательные действия.



43°C
C 227340 US
40°C for IEC/EN 60601-1
35°C for IEC/EN 60601-1-11

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IP22



Energy Verified
Reconnaissance
Energétique Vérifiée



PIN1,4: +V
PIN2,3: -V

MEAN WELL ENTERPRISES CO. LTD.
No. 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan
Manual: www.meanwell.com/manual



⚠ ОСТОРОЖНО ⚠
НЕ ОТКРЫВАТЬ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

S/N:



EB73051476

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ
MW02

S/N:



EC061G9494

MADE IN CHINA(中國製造)(中國製造) MW02


Фото 5. Блок питания Meanwell Модель GSM160B24-R7B. Маркировка

07-01-2026
REF 0024.060
LOT 2101-01

CE
0051



STERILE R



BIONEN s.a.s
Via P. Petrocchi, 42/1,
50127 Firenze, Italia

Фото 6. Маркировка первичной упаковки электрода-иглы

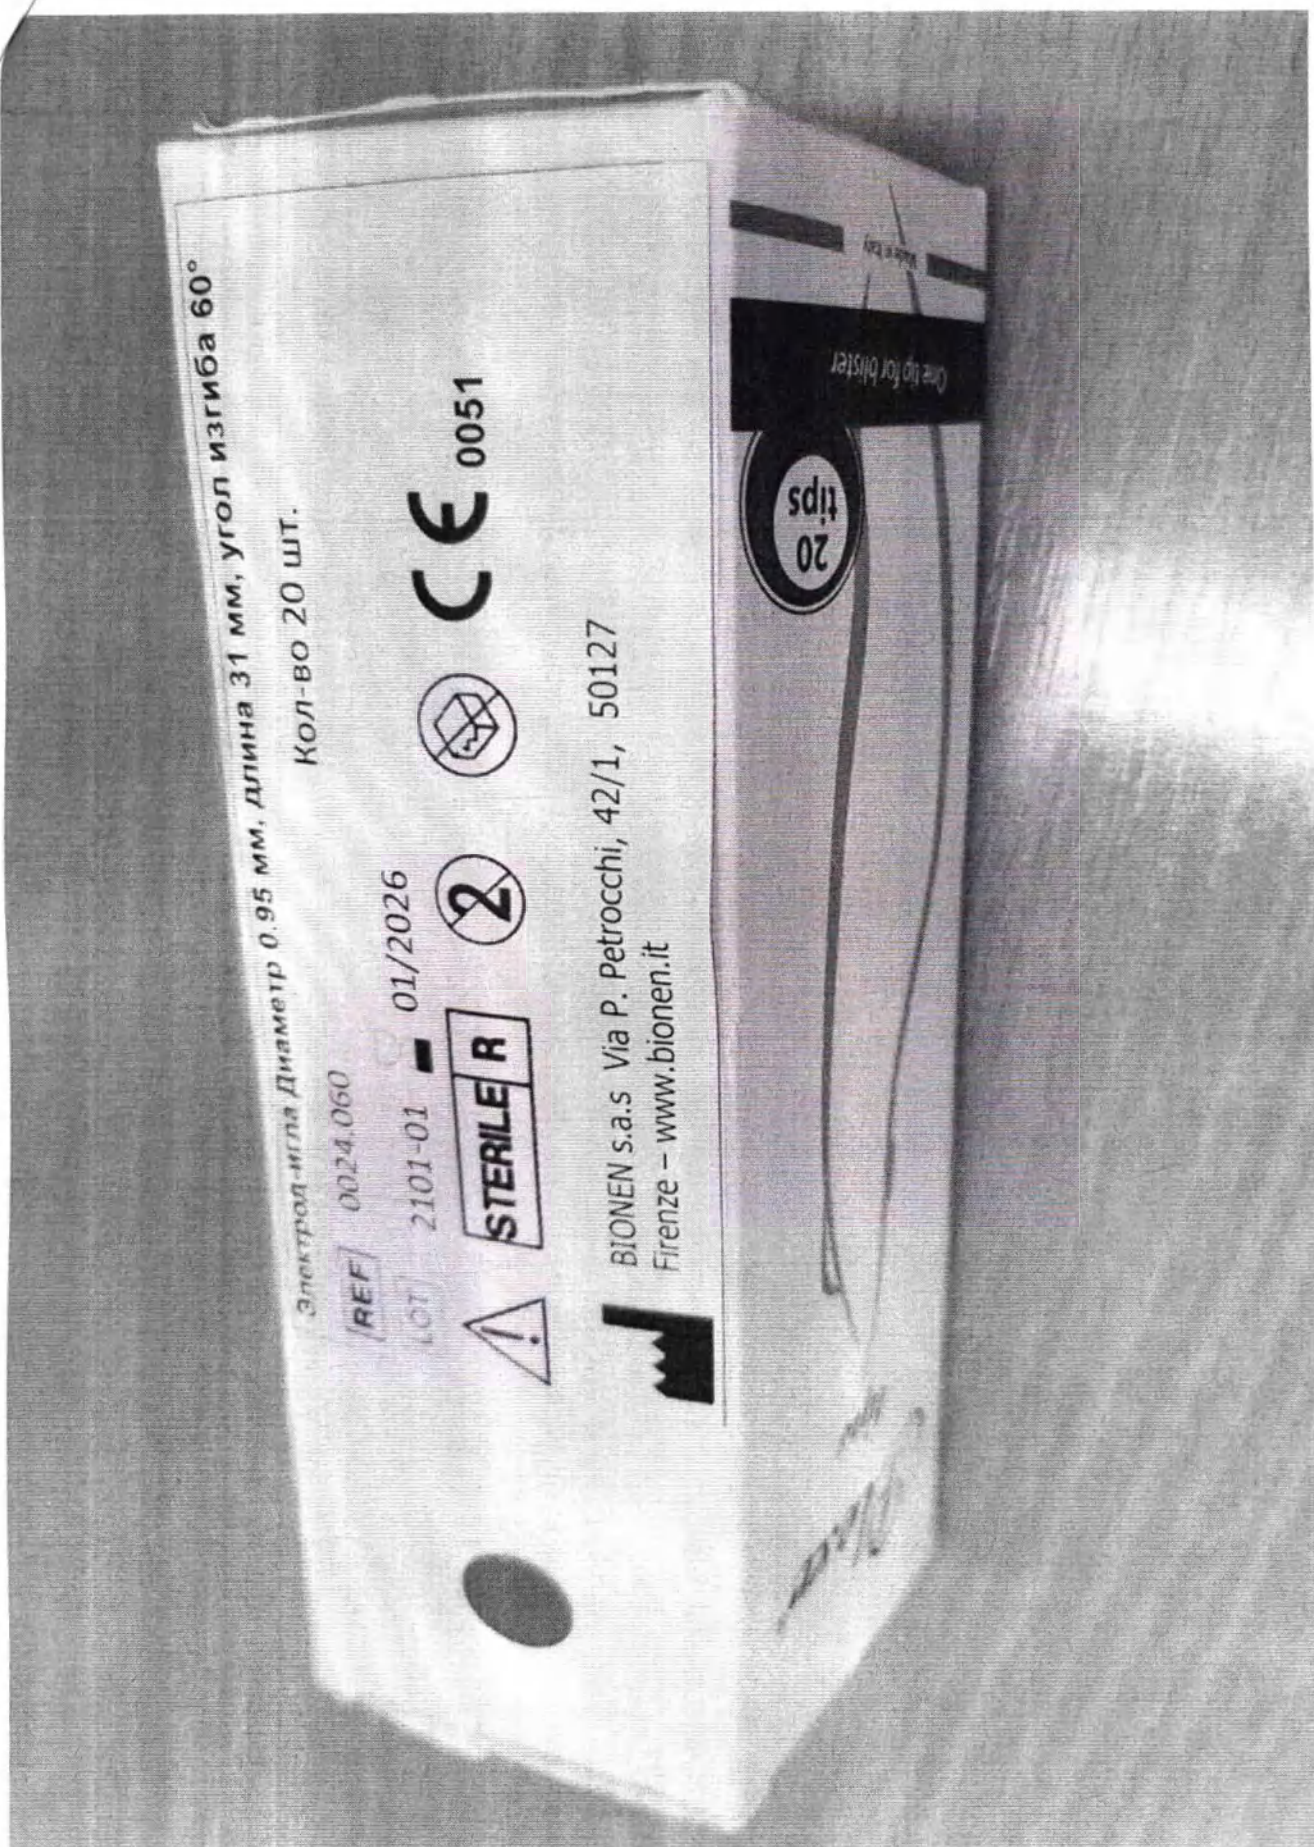


Фото 7. Маркировка групповой упаковки электрода-иглы

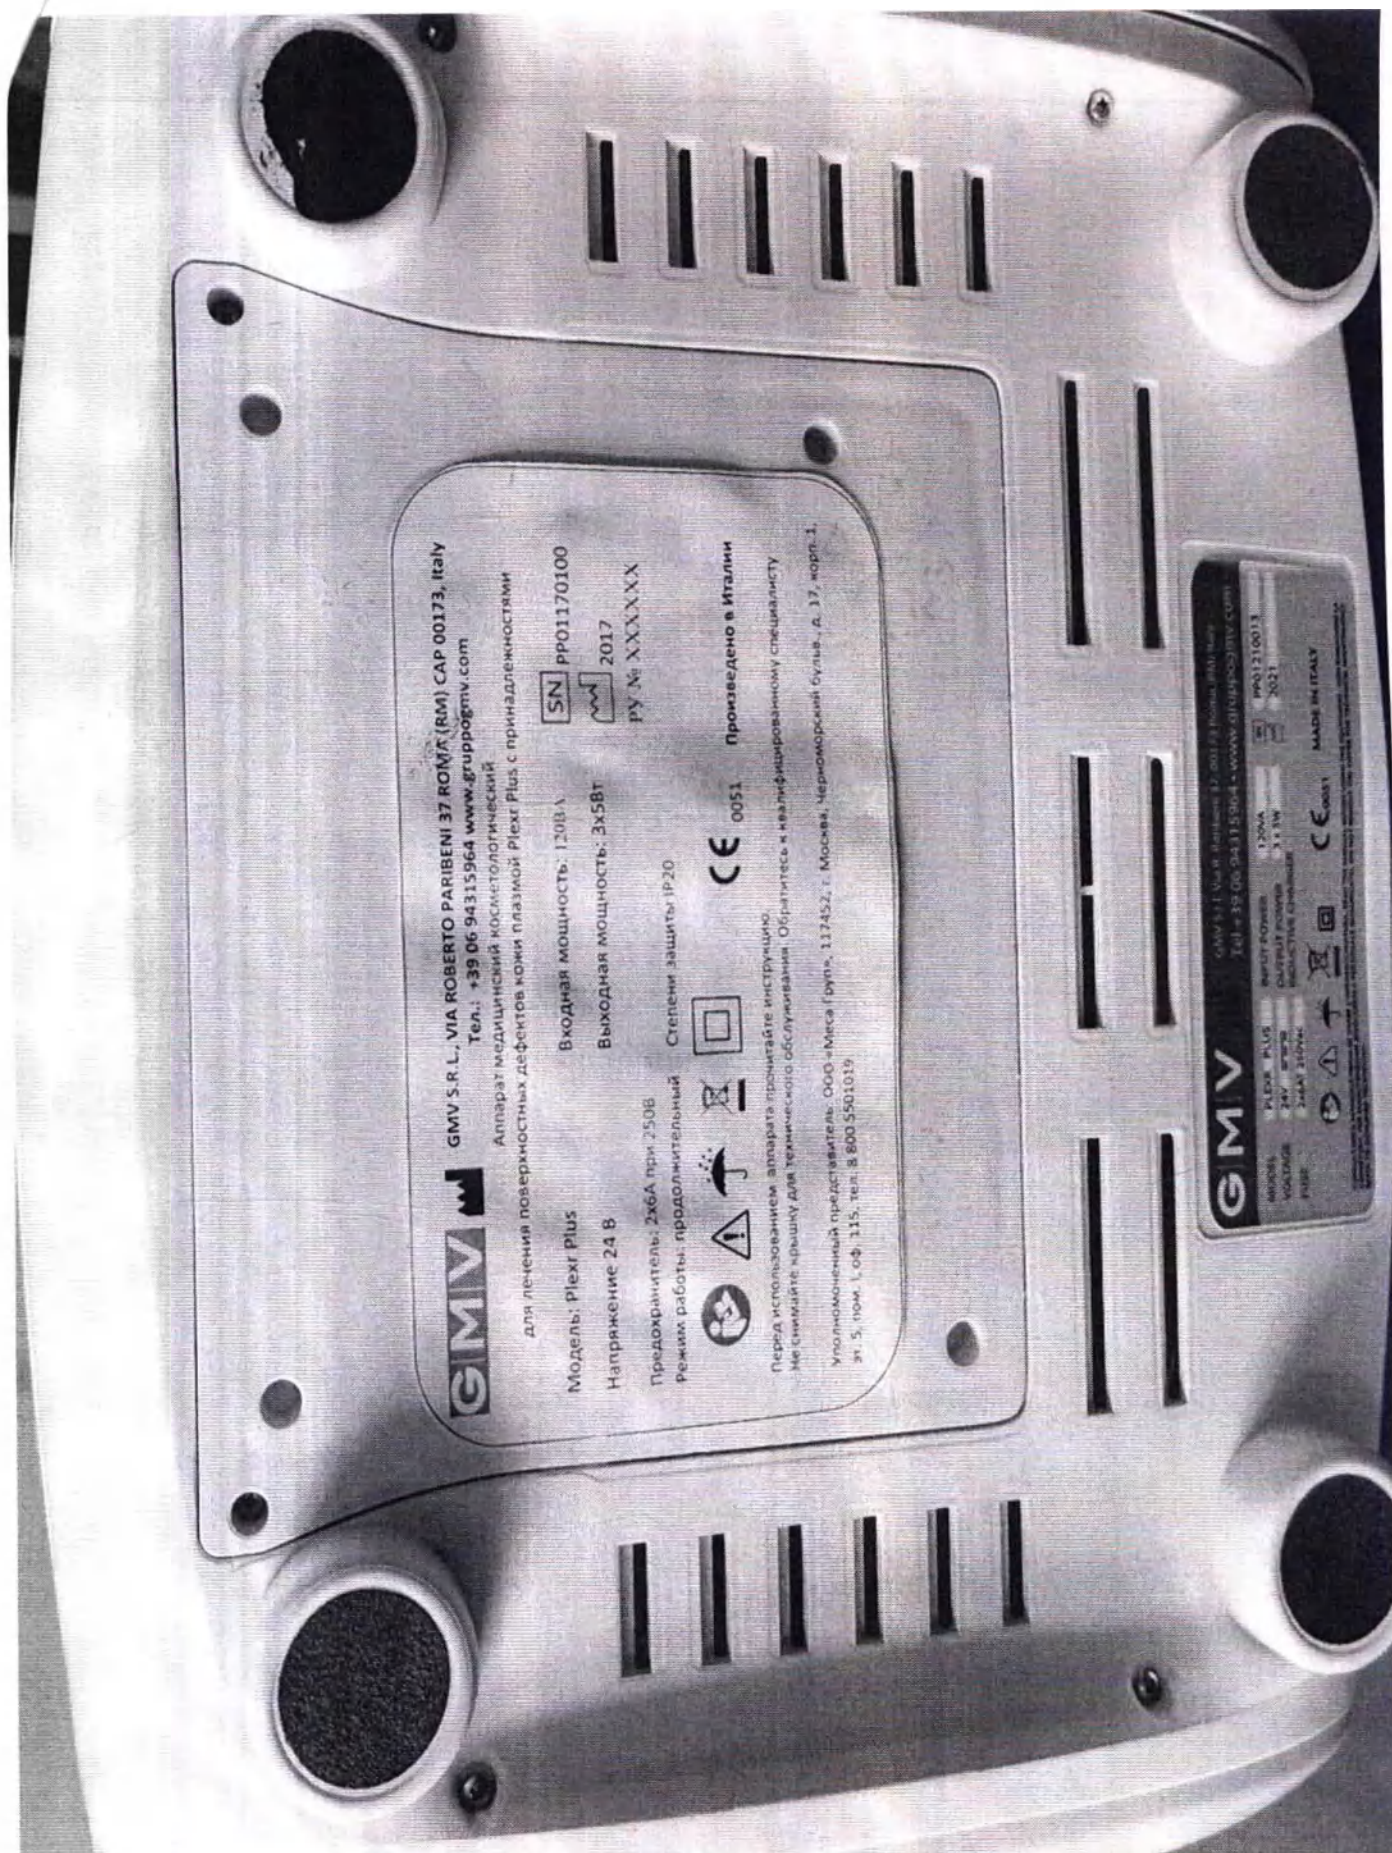


Фото 8. Основная док-станция Plexr Plus. Маркировка

Фото 9. Маркировка мобильного блока зарядки





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10 листов
Подпись [signature]