

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Маке»

А. М. Медникова

«30 апреля» 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система анестезиологическая Flow-с.




Производитель: MAQUET CRITICAL CARE AB (Маке Критикал Кэа АБ).


Адрес: Röntgentvägen 2, SE-171 54 Solna, SWEDEN (Рёнтгентваген 2, SE-171 54 Сольна, Швеция)


Место производства: MAQUET CRITICAL CARE AB (Маке Критикал Кэа АБ),
Röntgentvägen 2, 171 54 Solna, SWEDEN (Рёнтгентваген 2, 171 54 Сольна, Швеция)

Базовый блок.

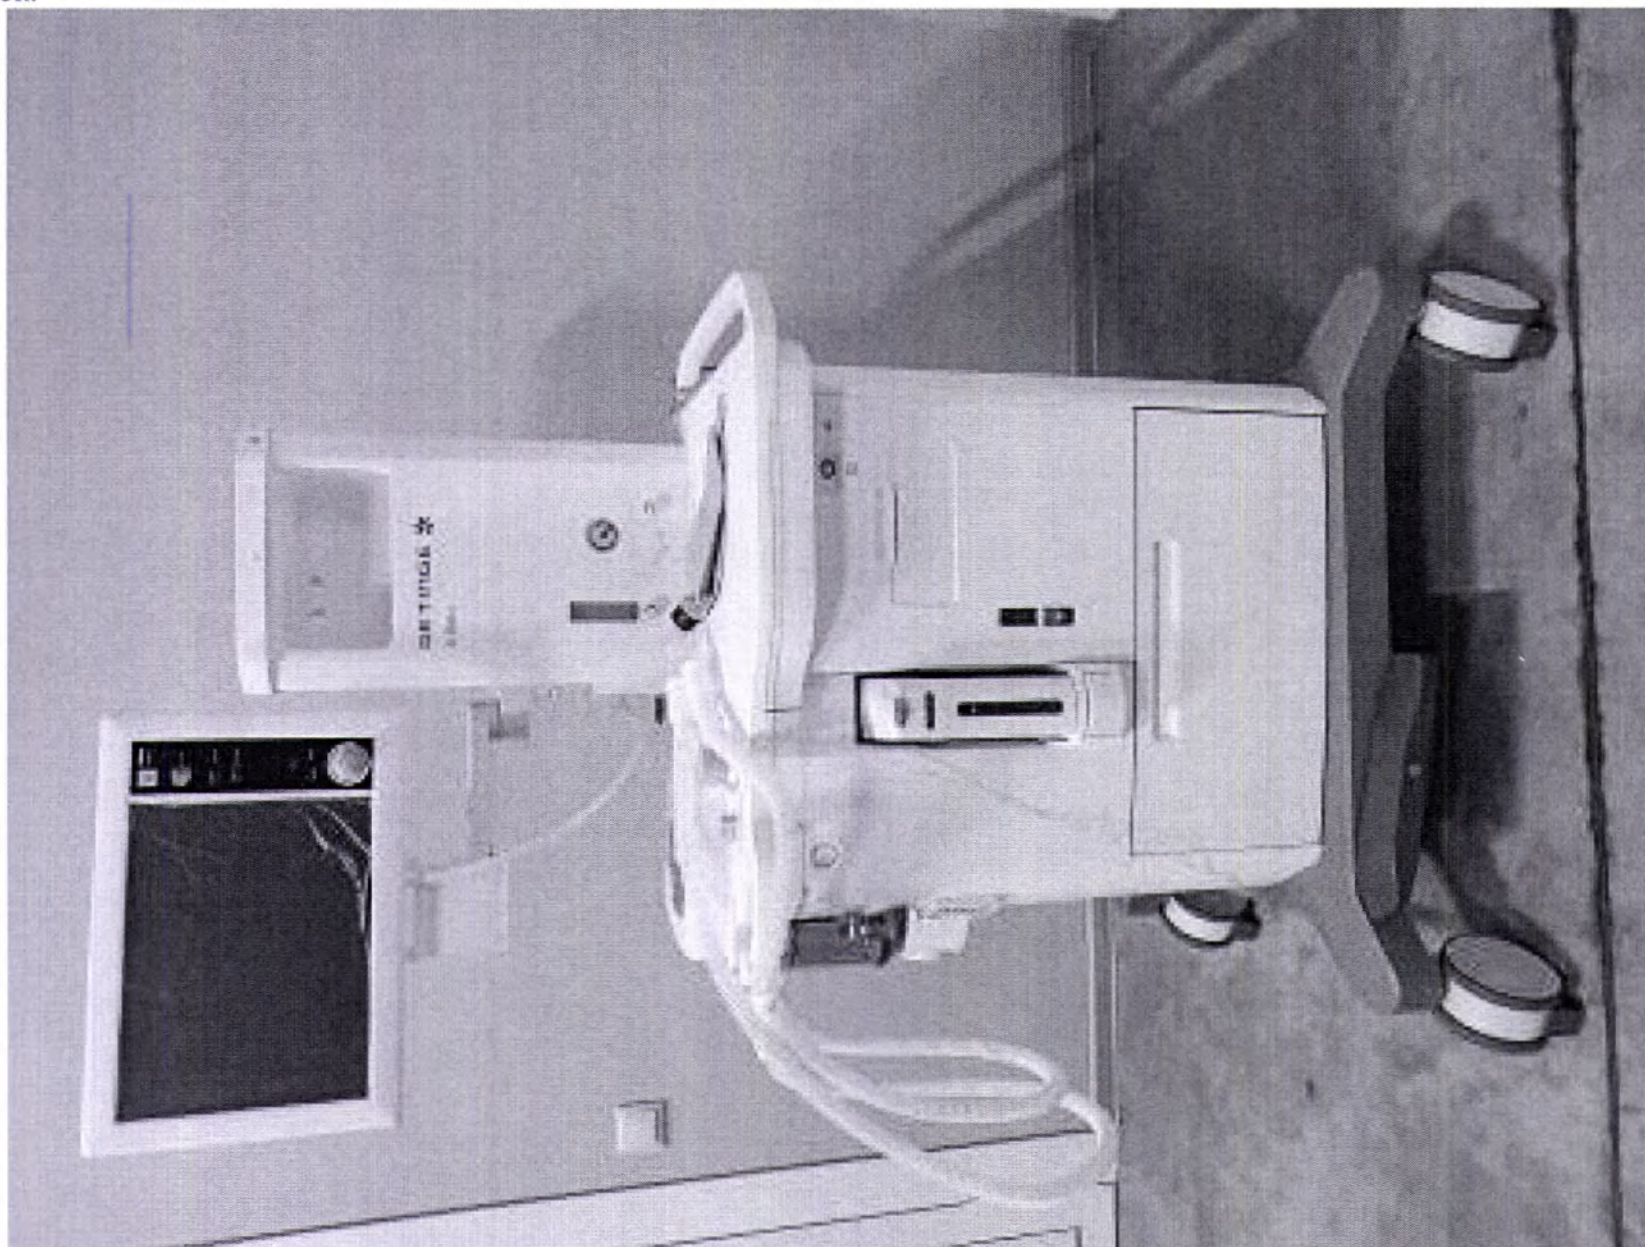


Панель управления.

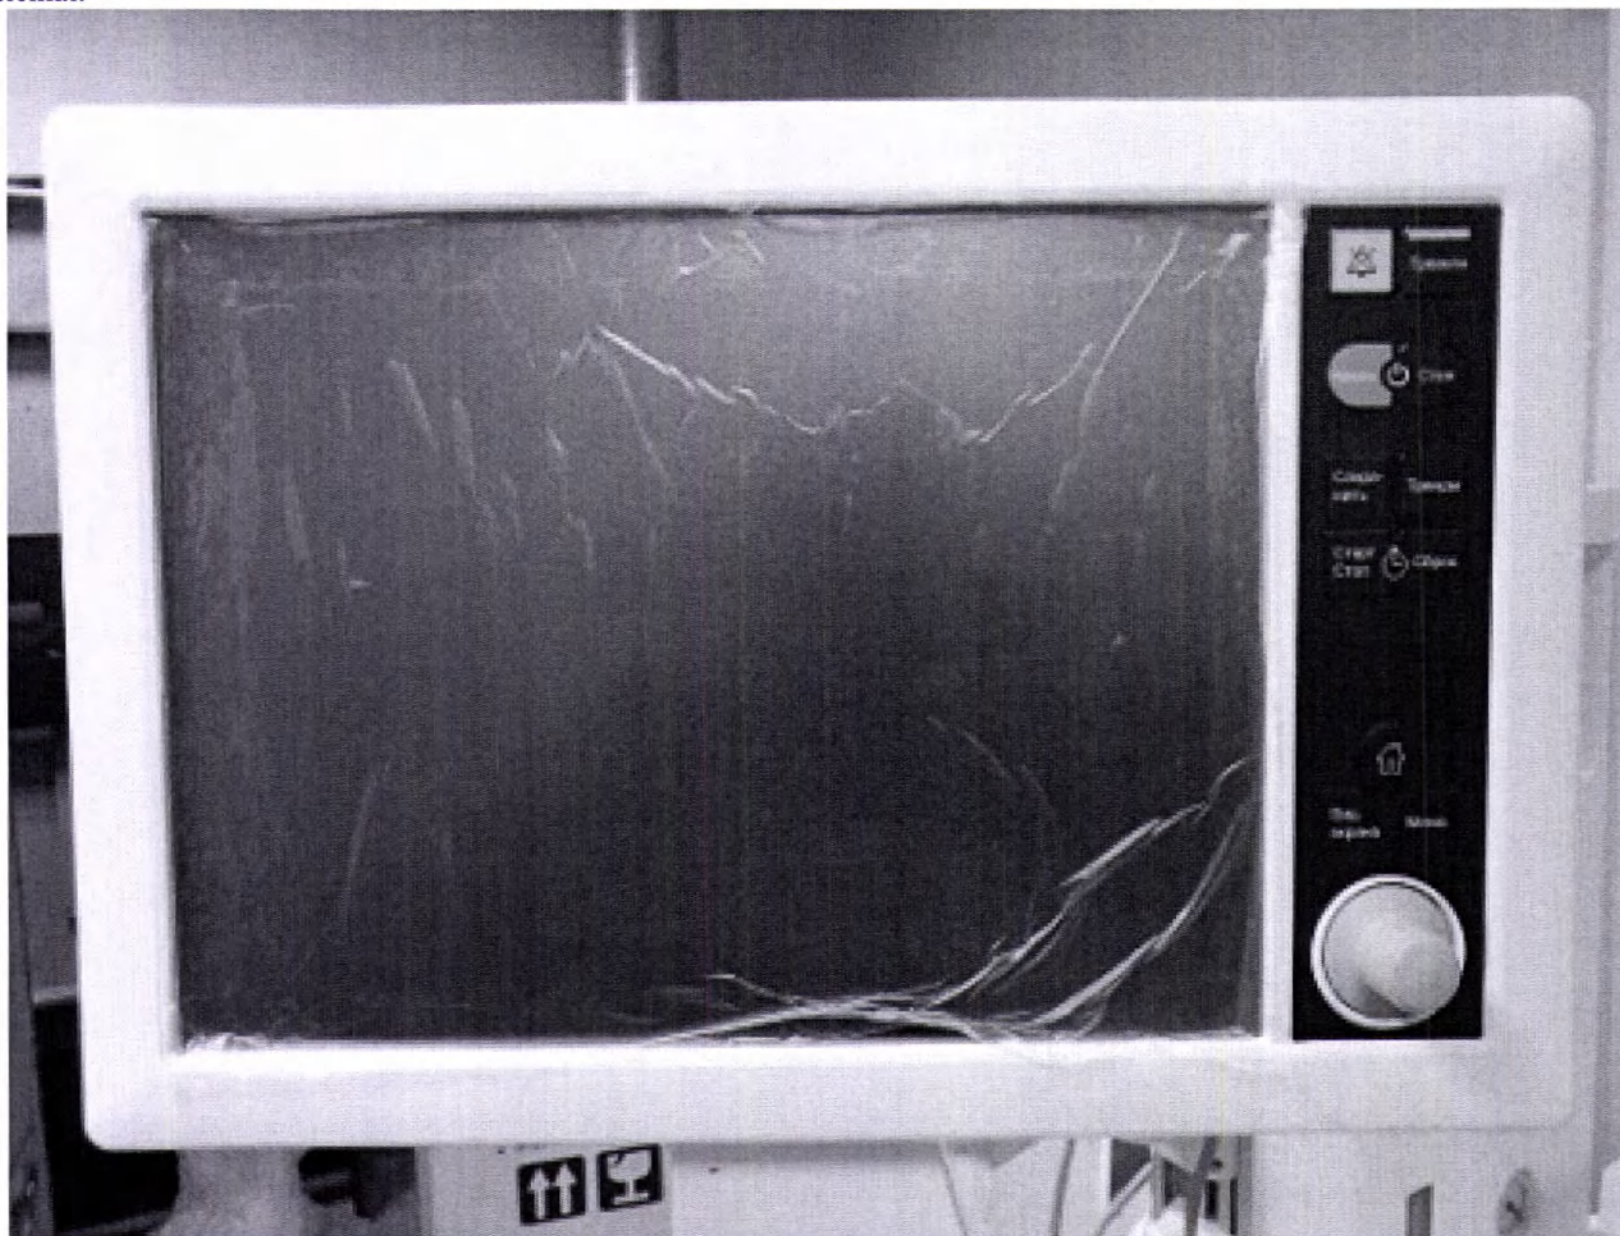


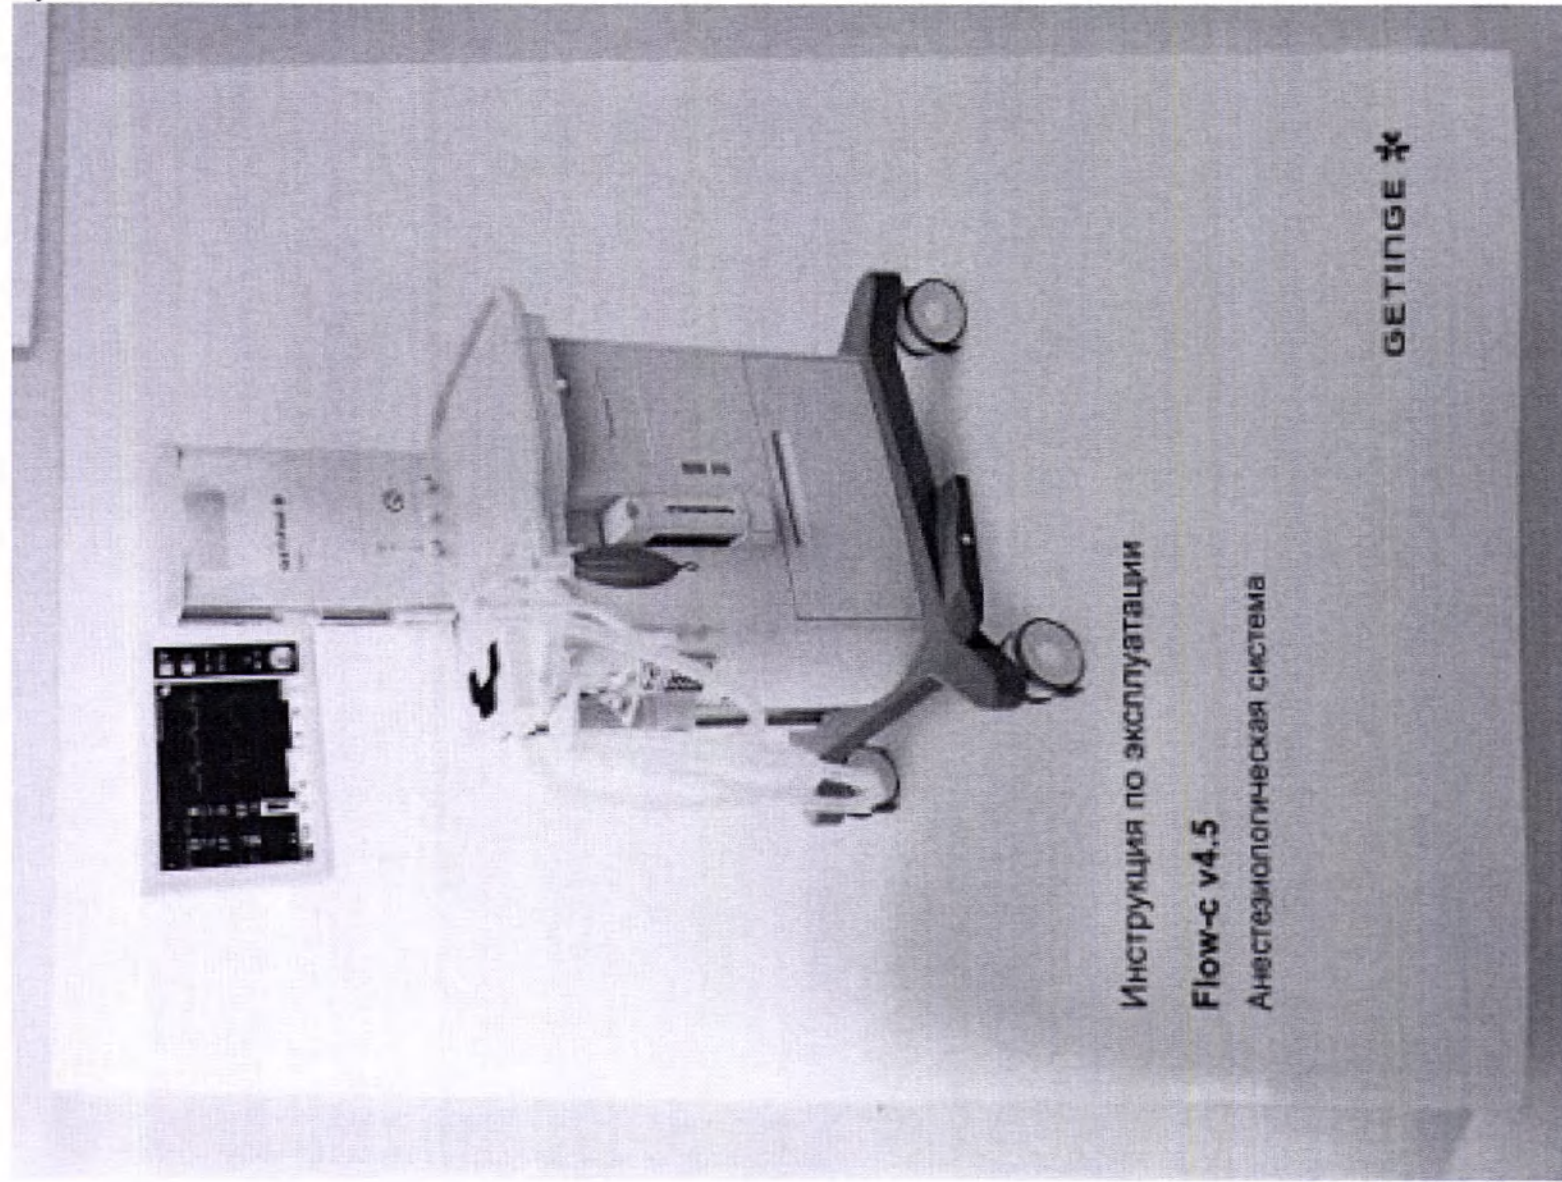


Кассета пациента.

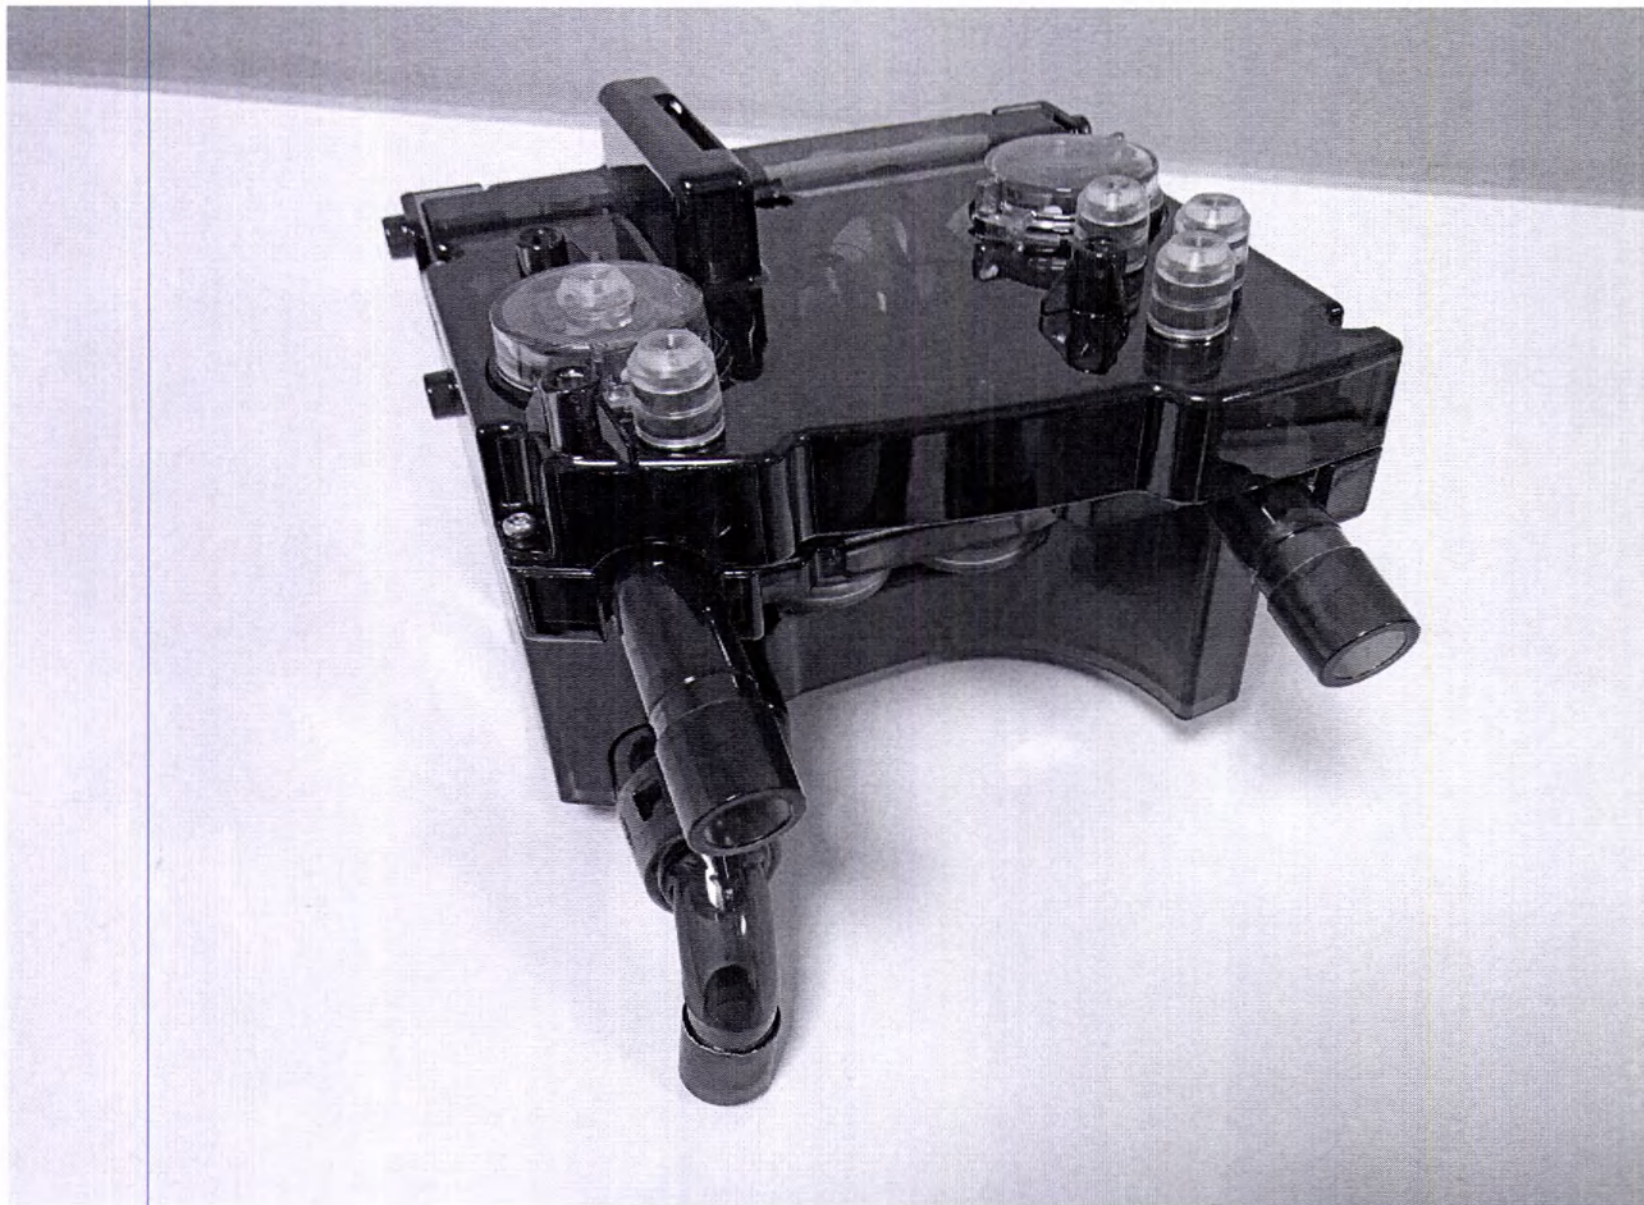


Крышка кассеты пациента клапанная.

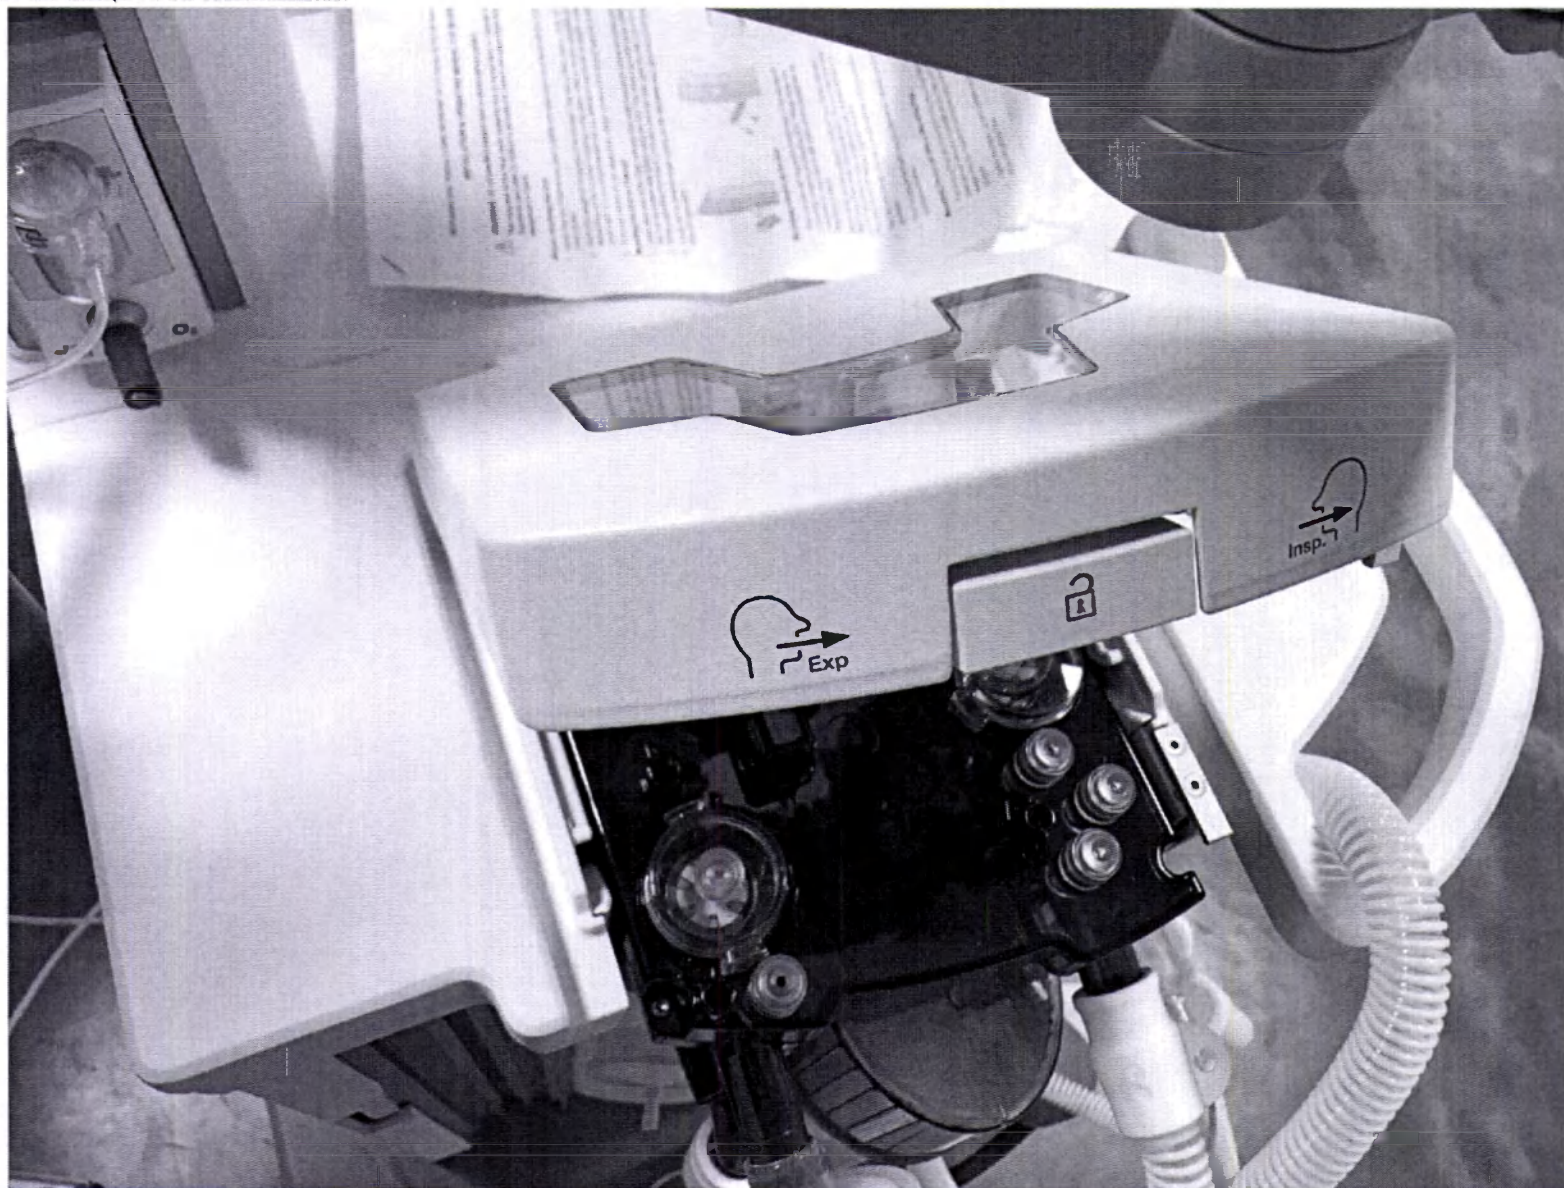


Адаптер для кассеты пациента.

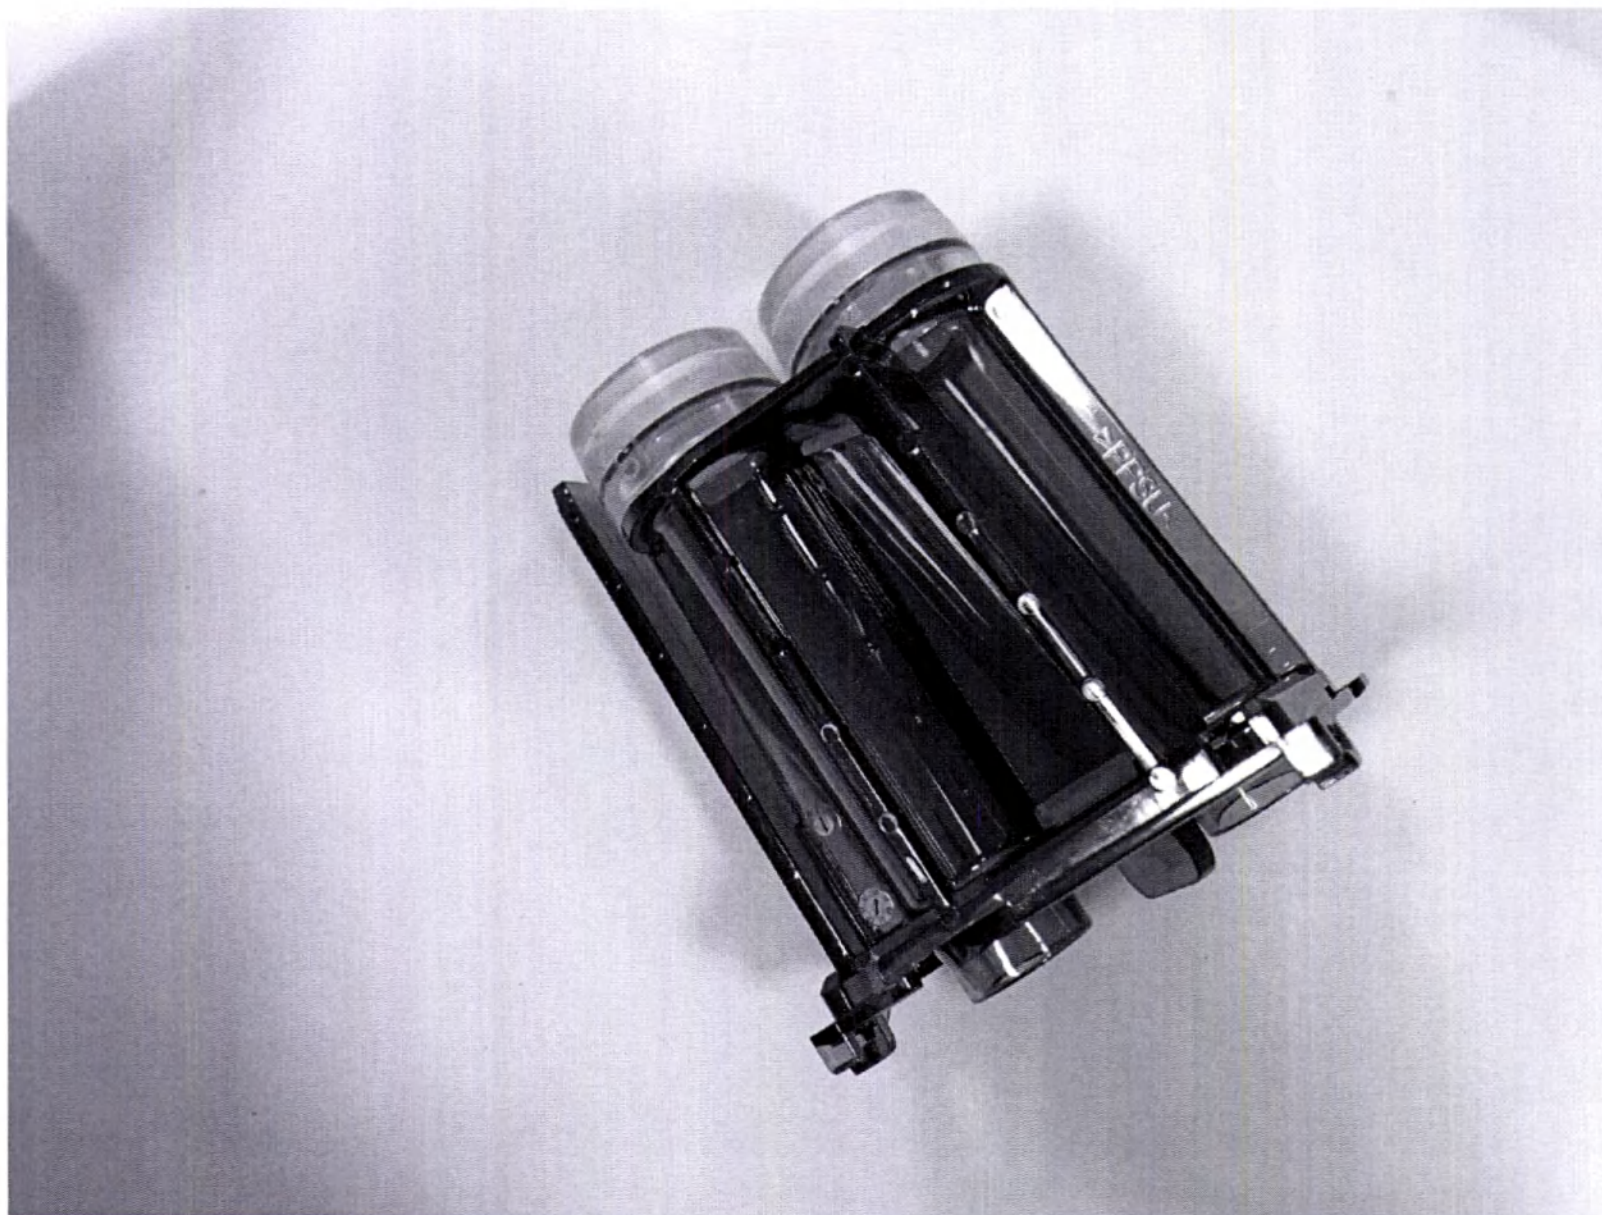


Рефлектор объёма.

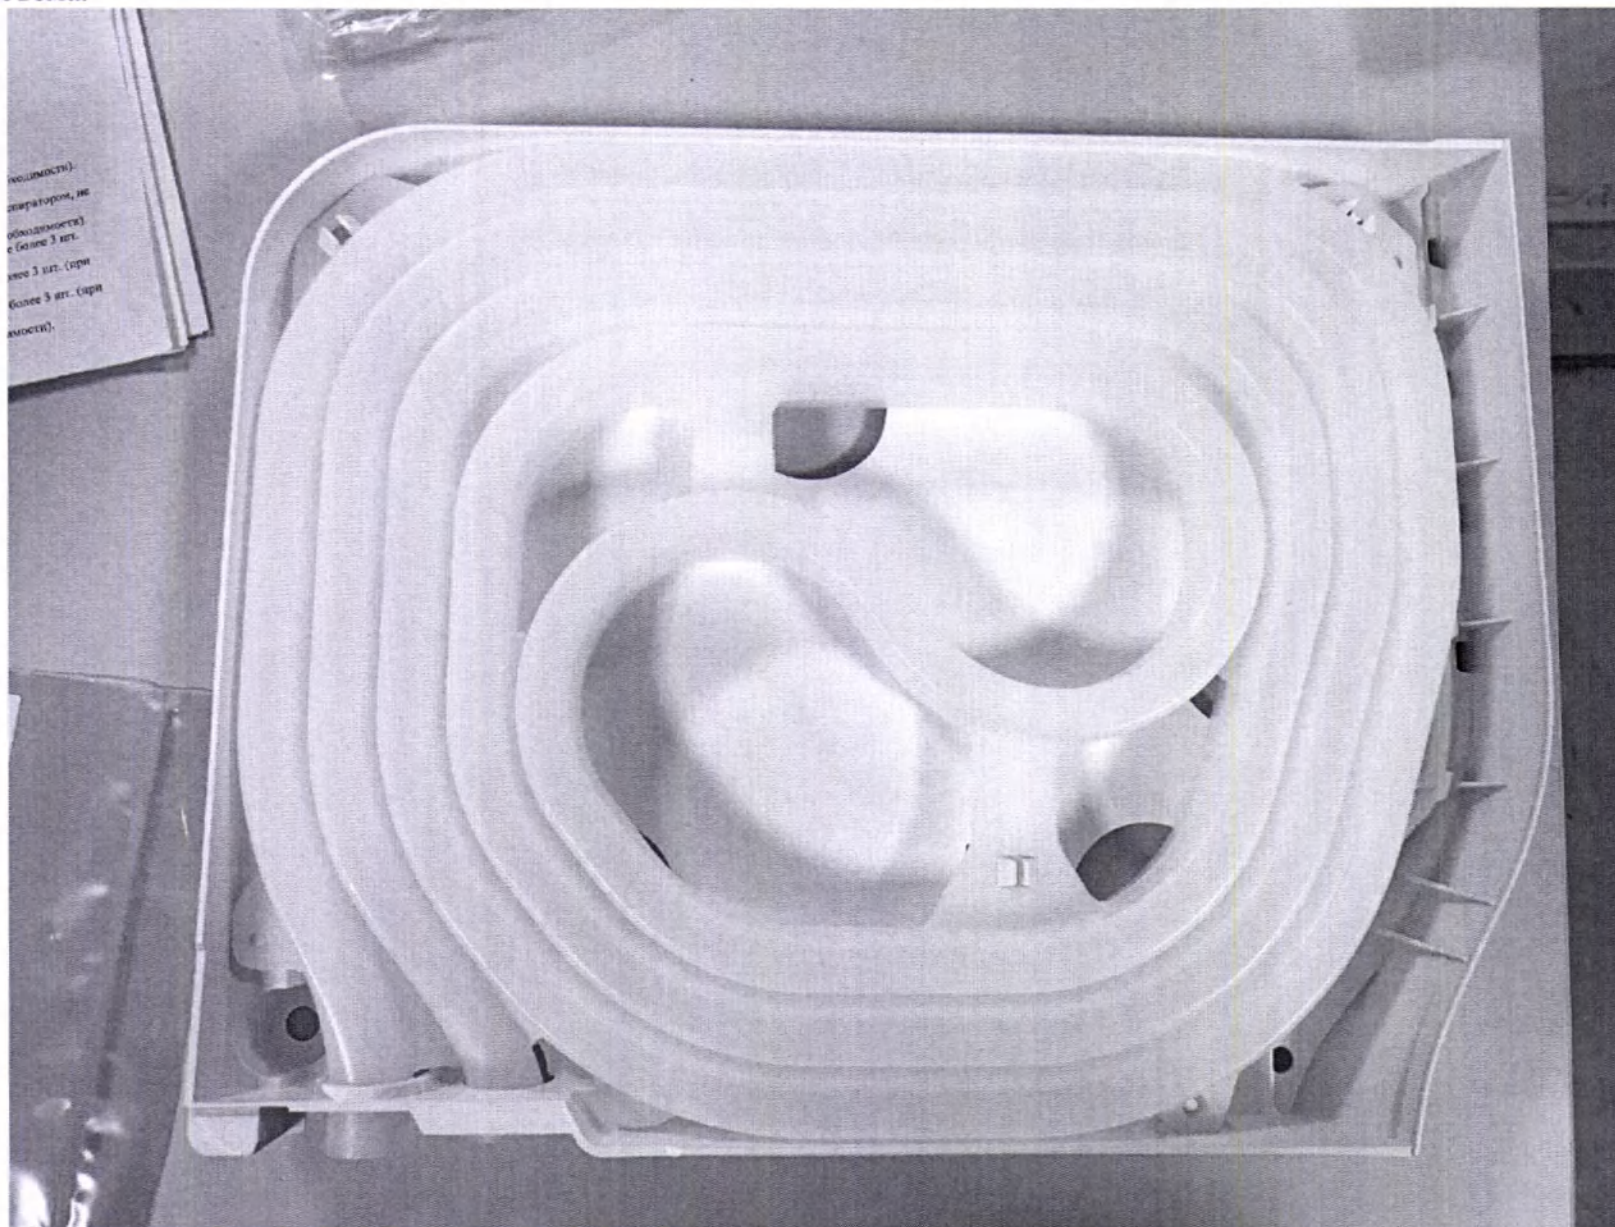


Блок подачи и вывода газов.

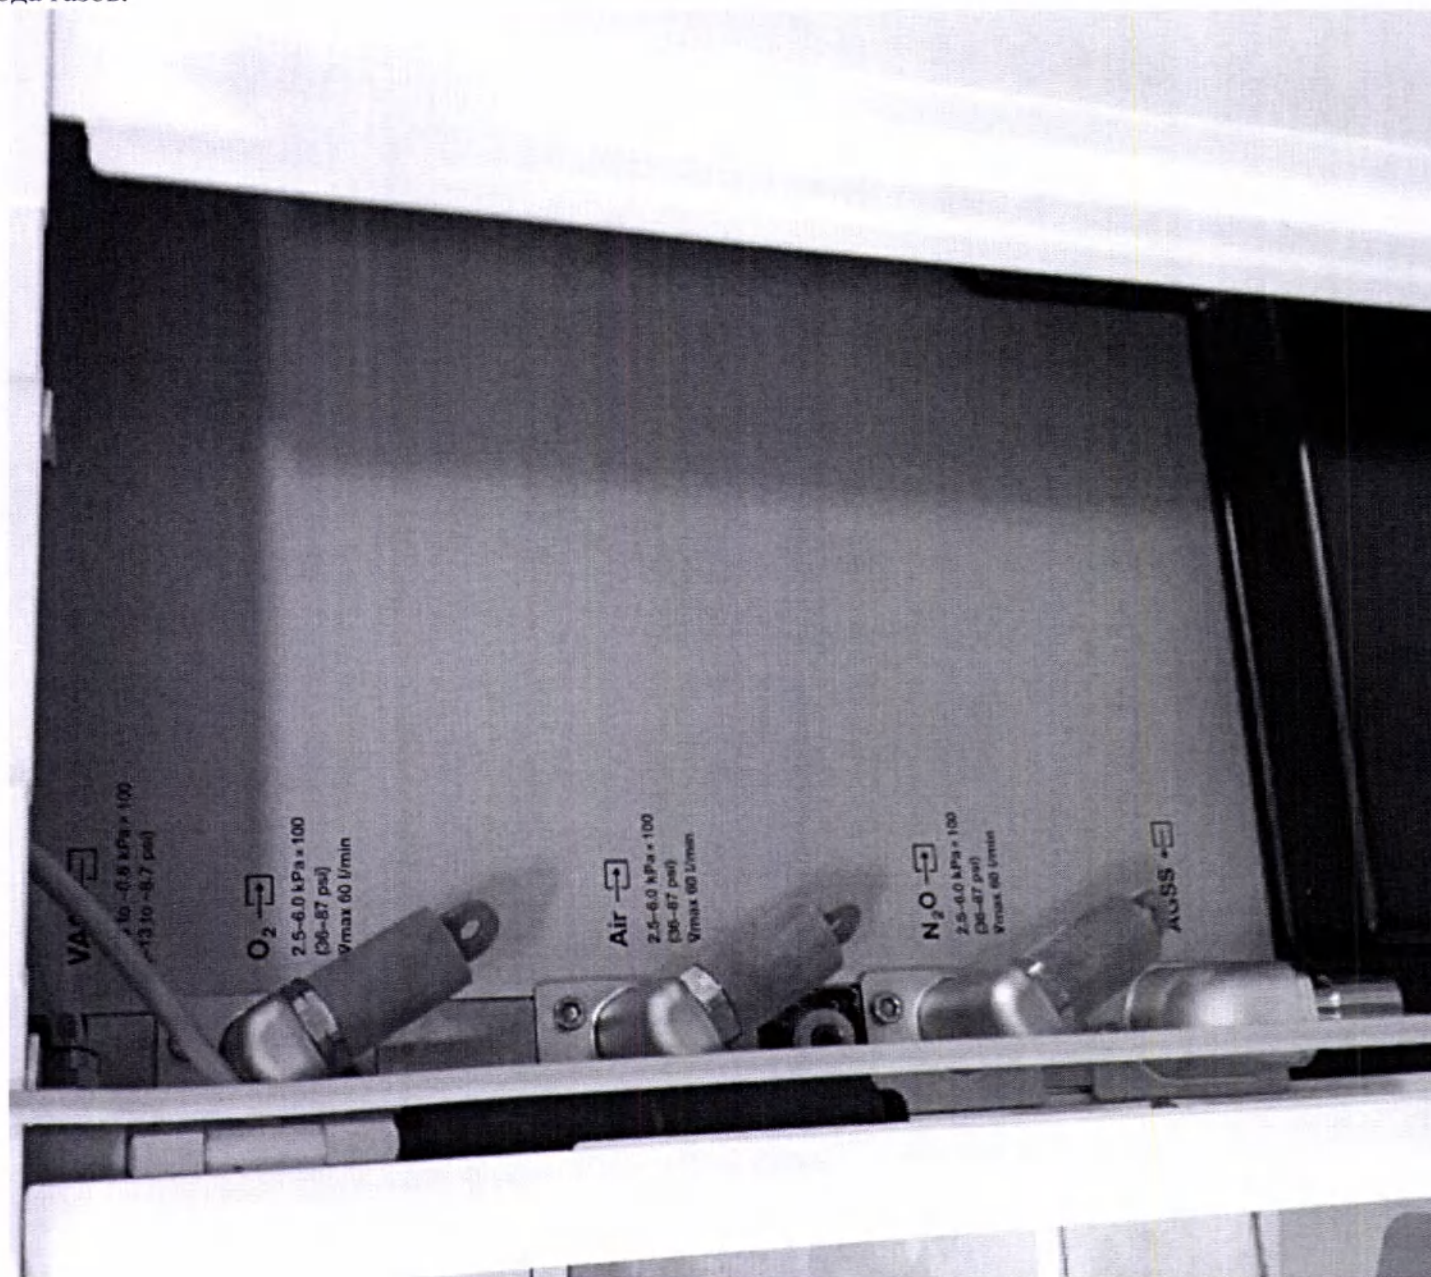


Клапан APL регулировки предельного давления.

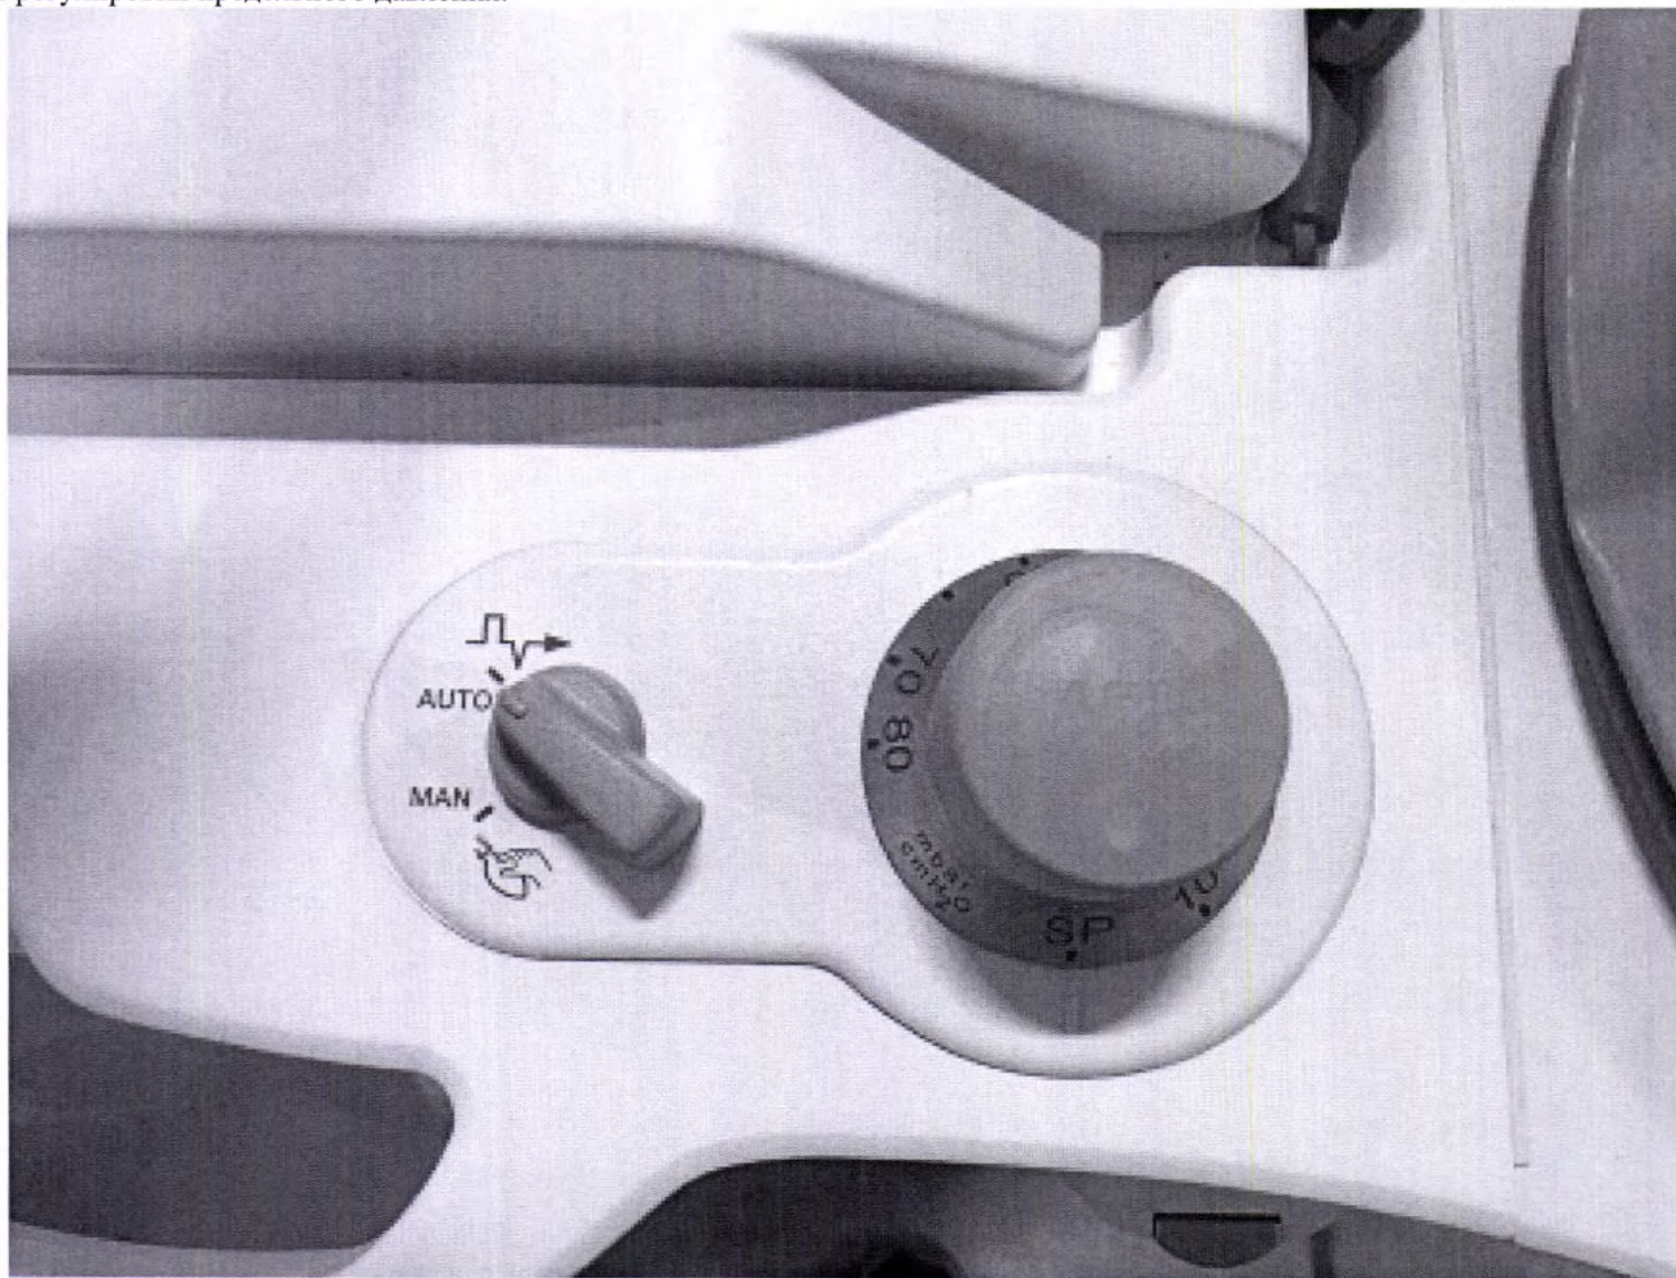


Влагоуловитель.

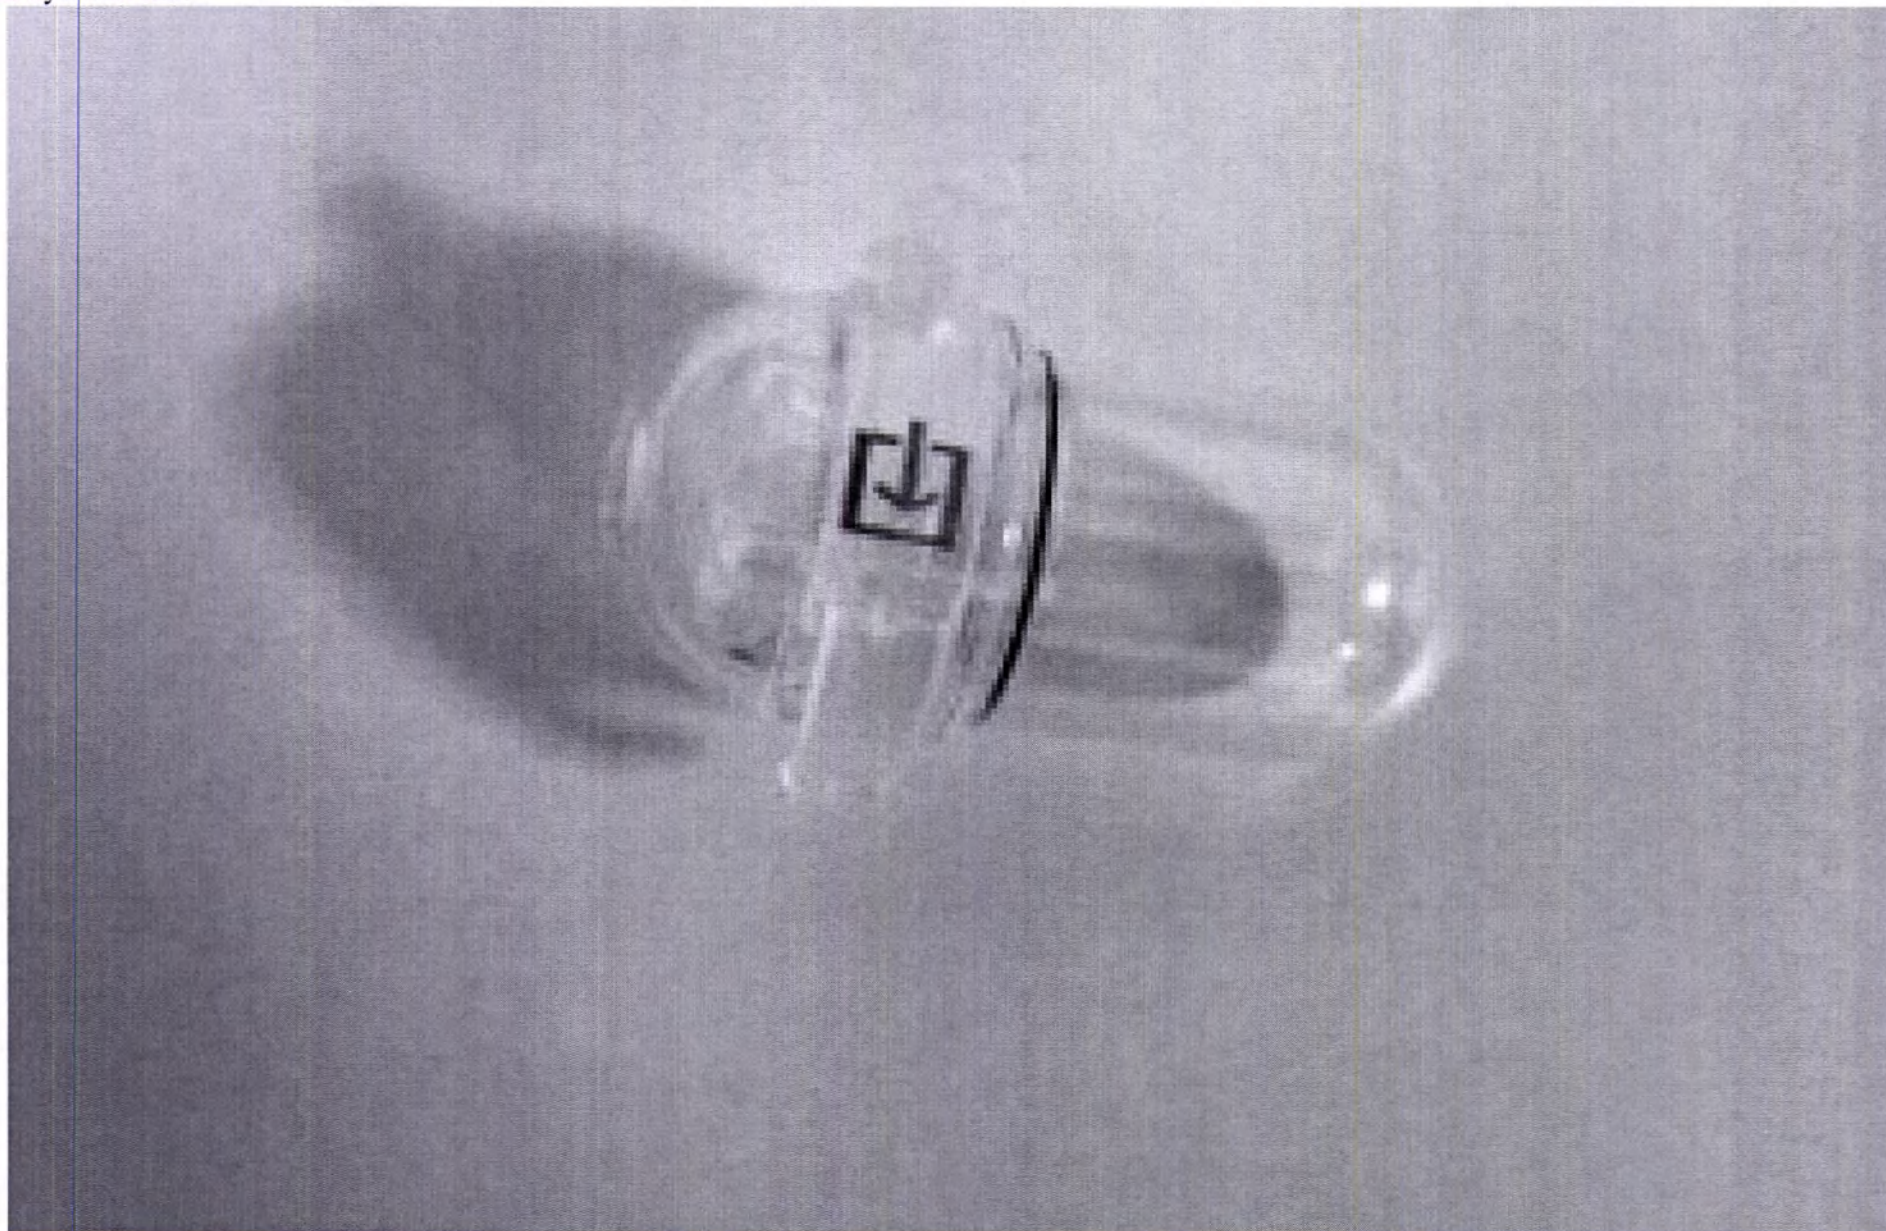


Линия отбора проб.

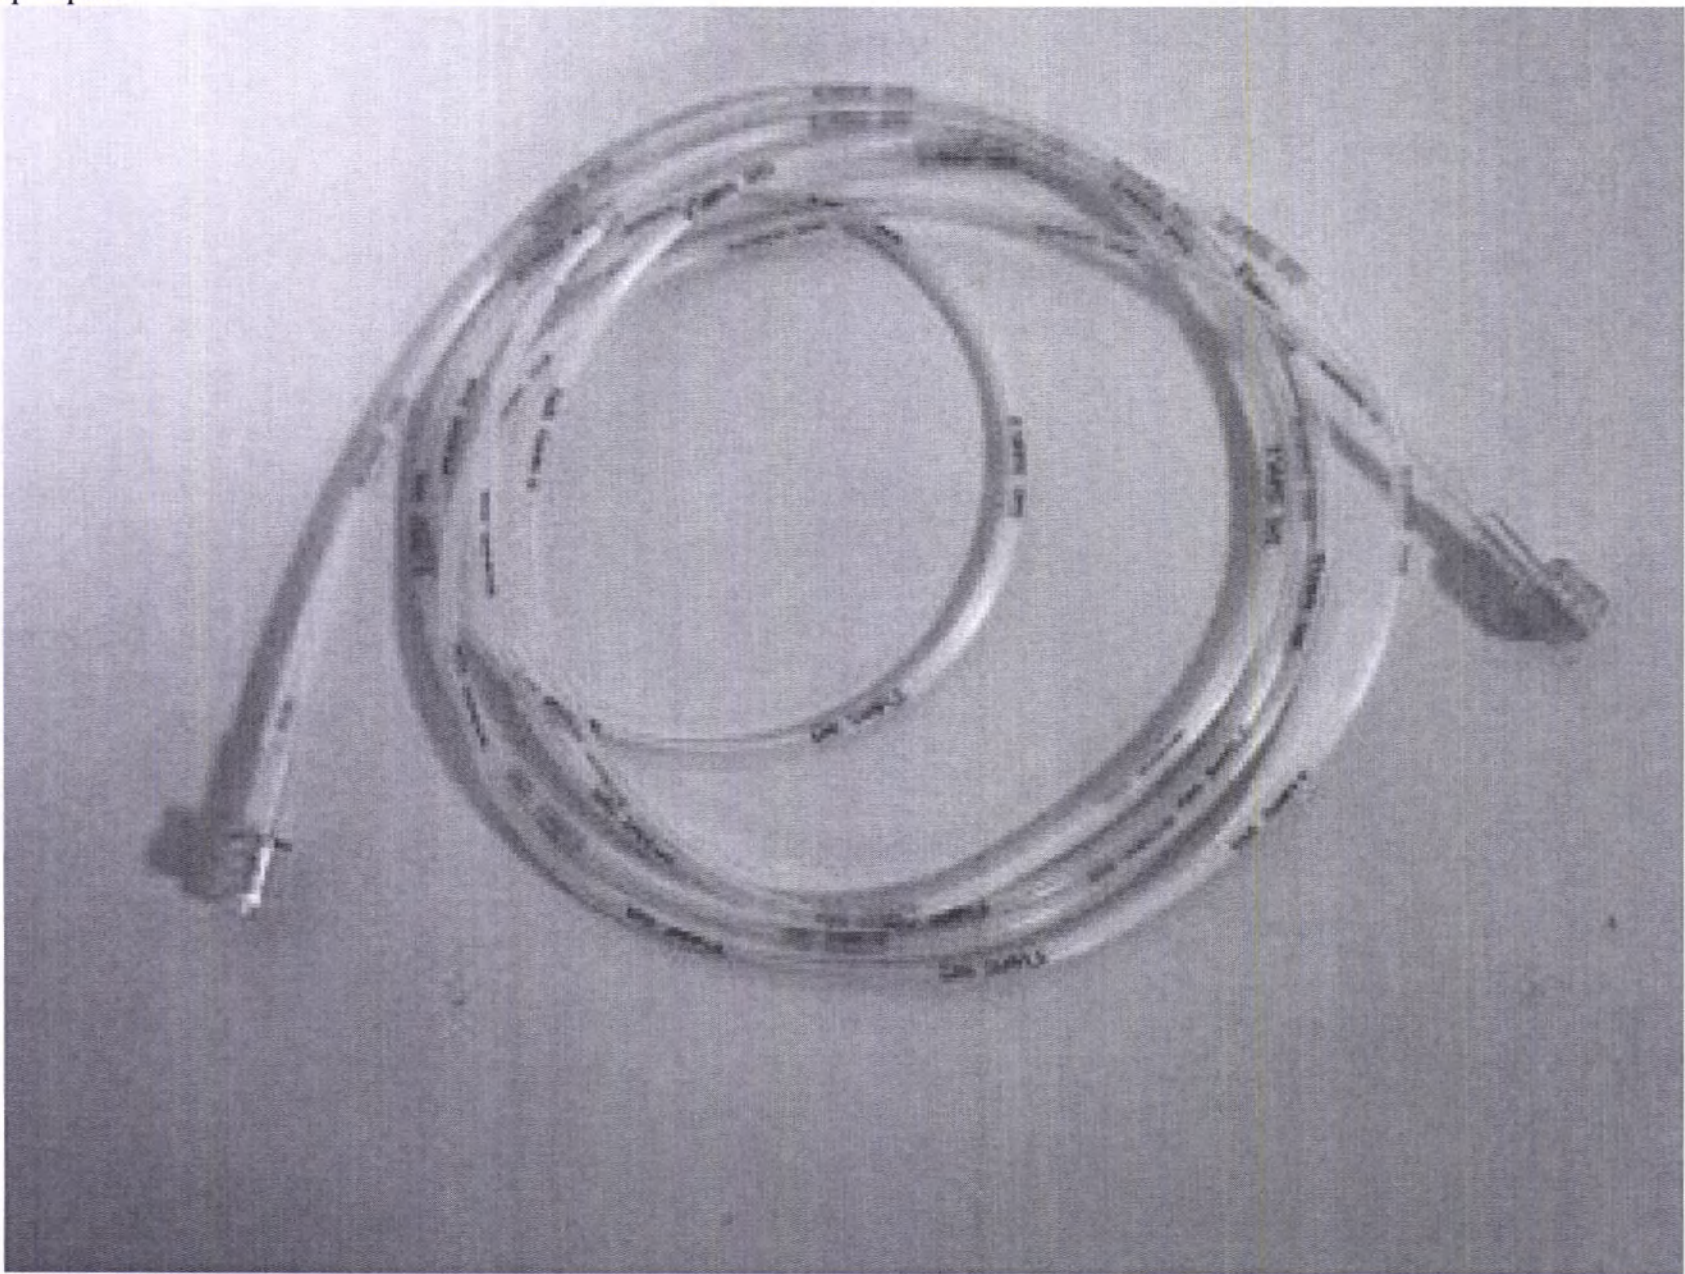


Кронштейн для панели управления.

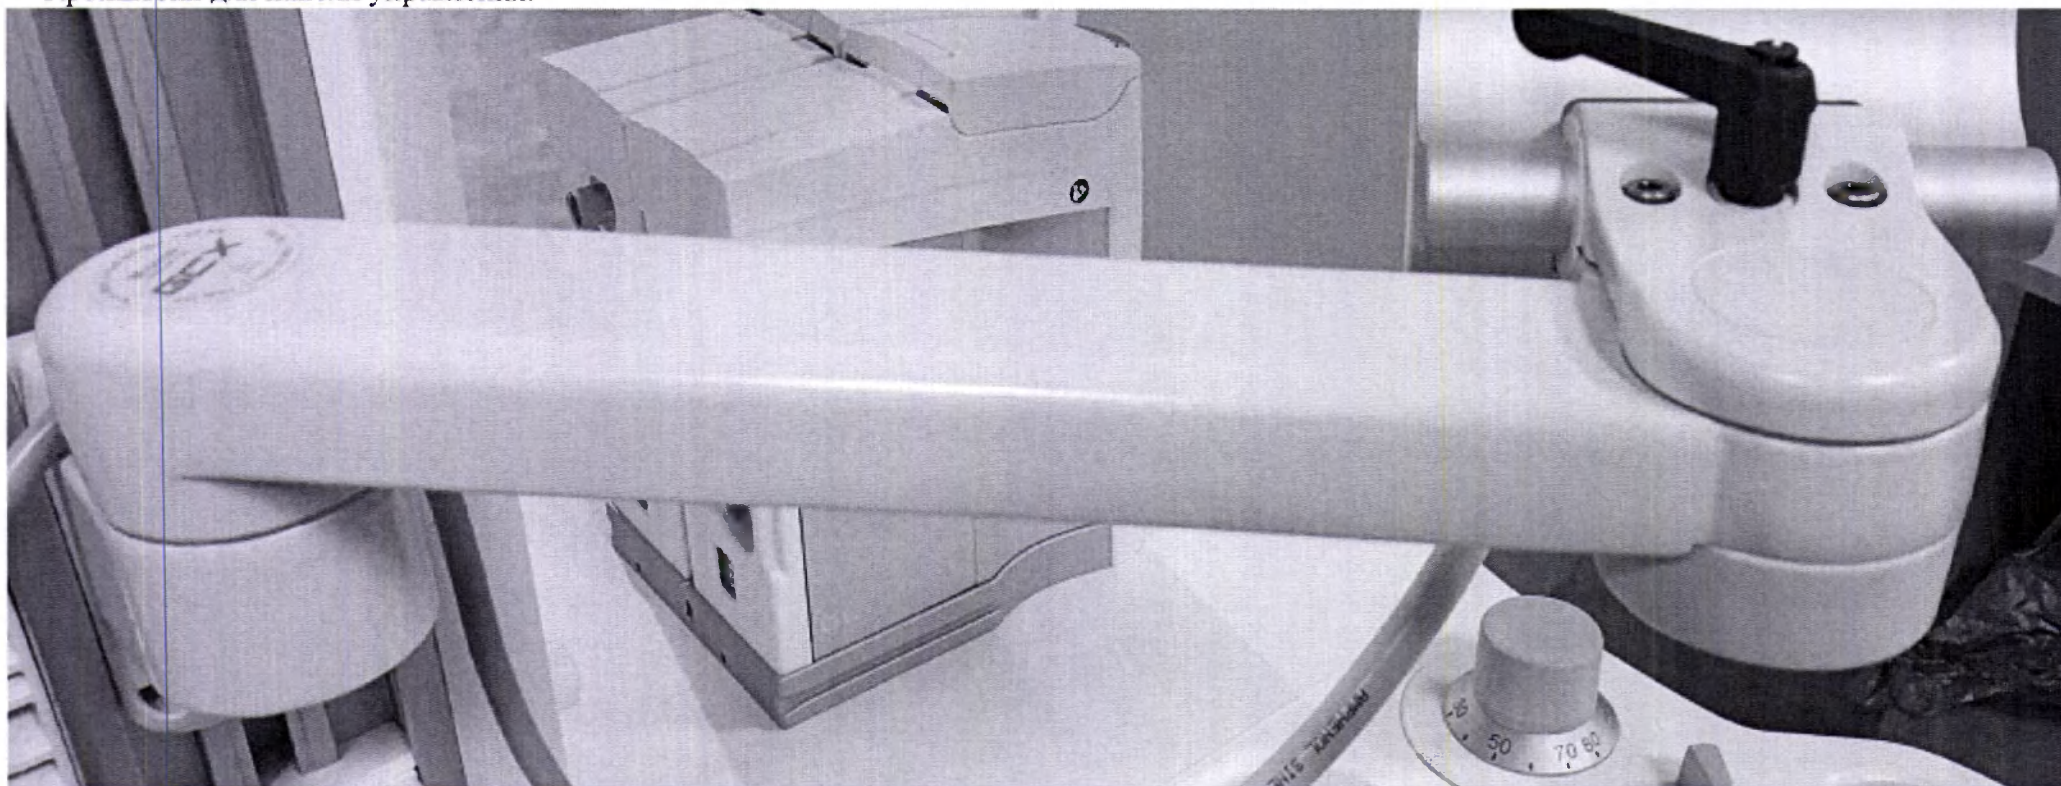


Кронштейн для монитора.

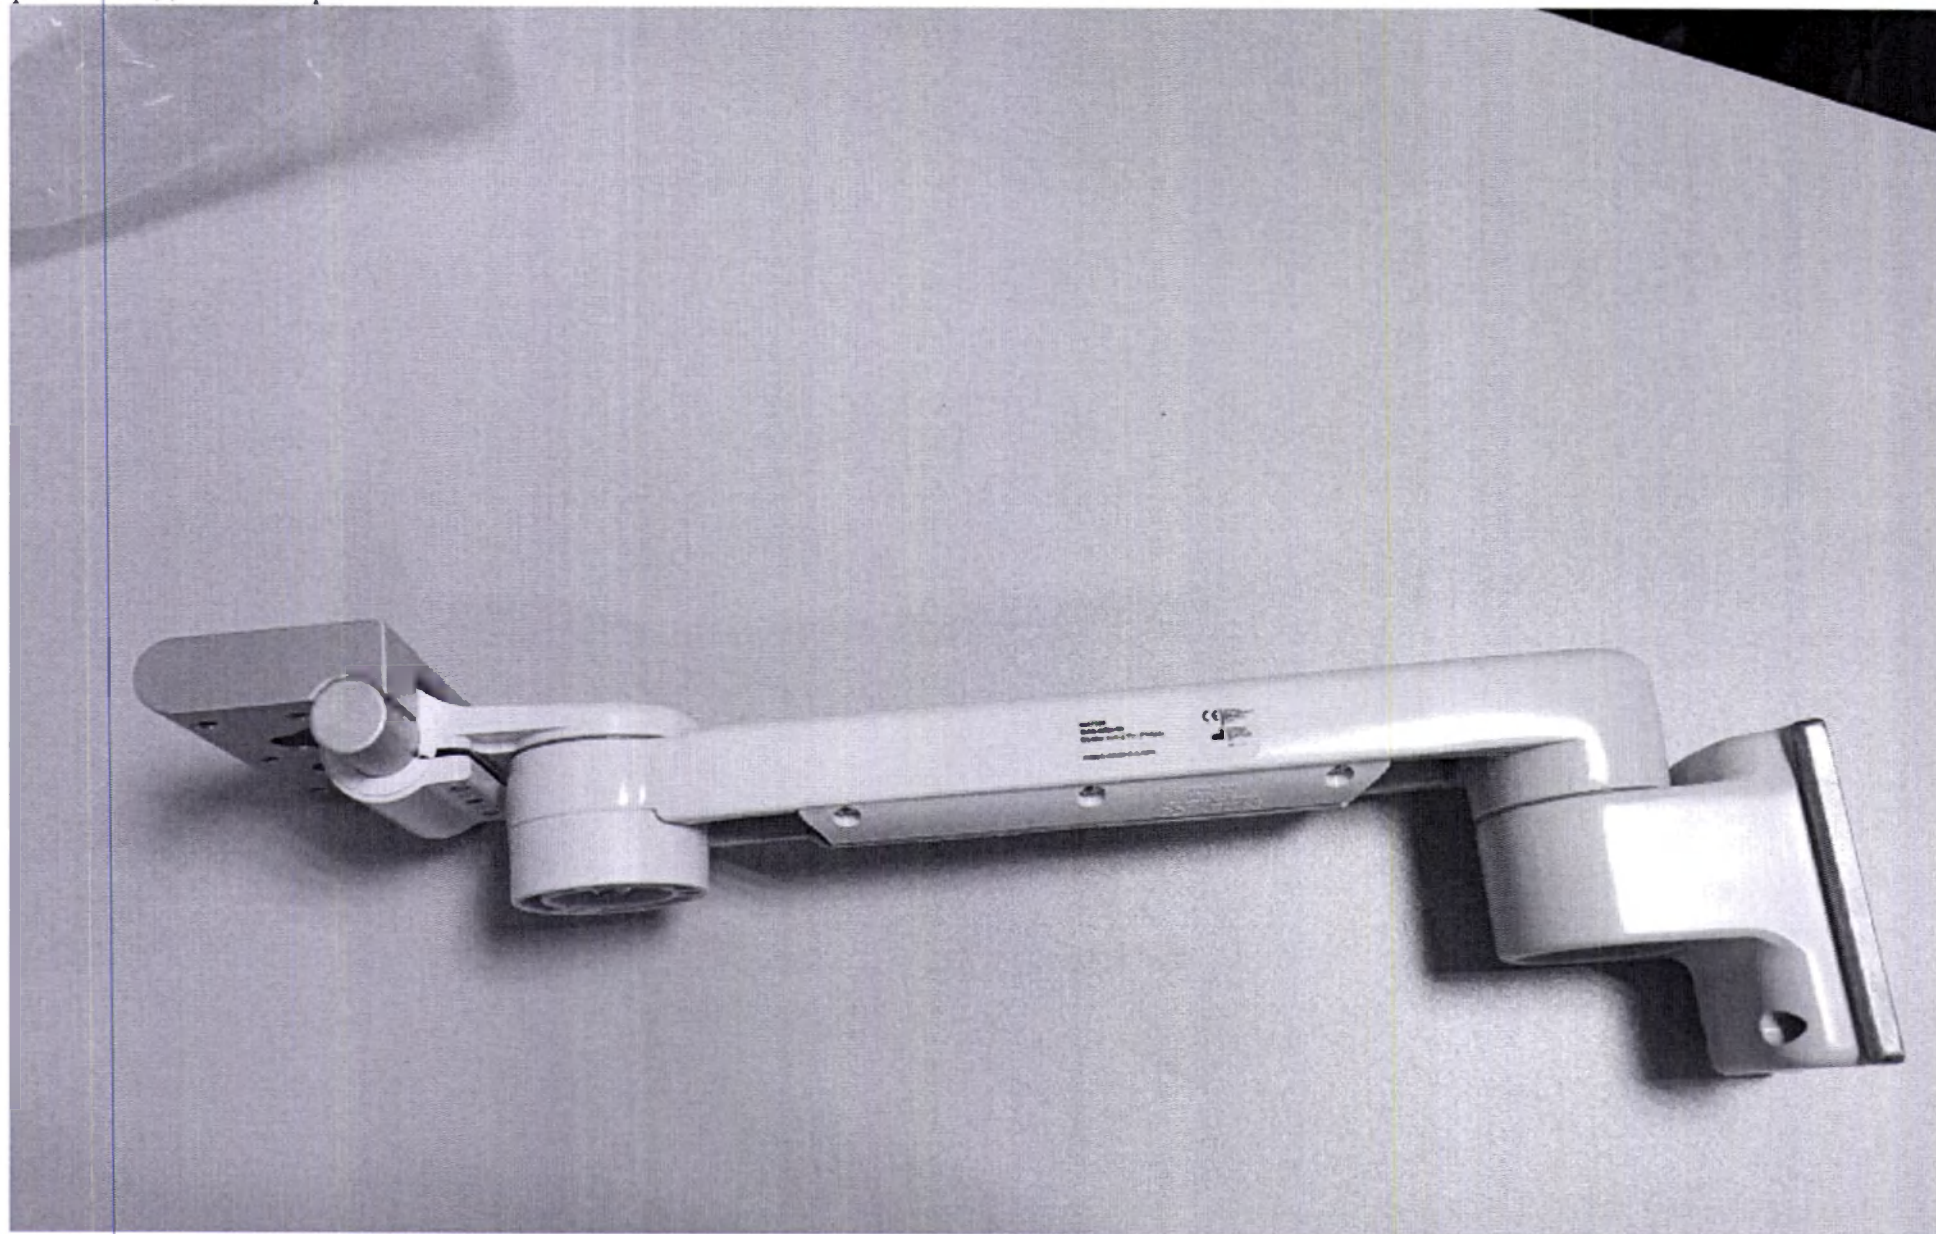


Съемная пластина кронштейна для монитора.

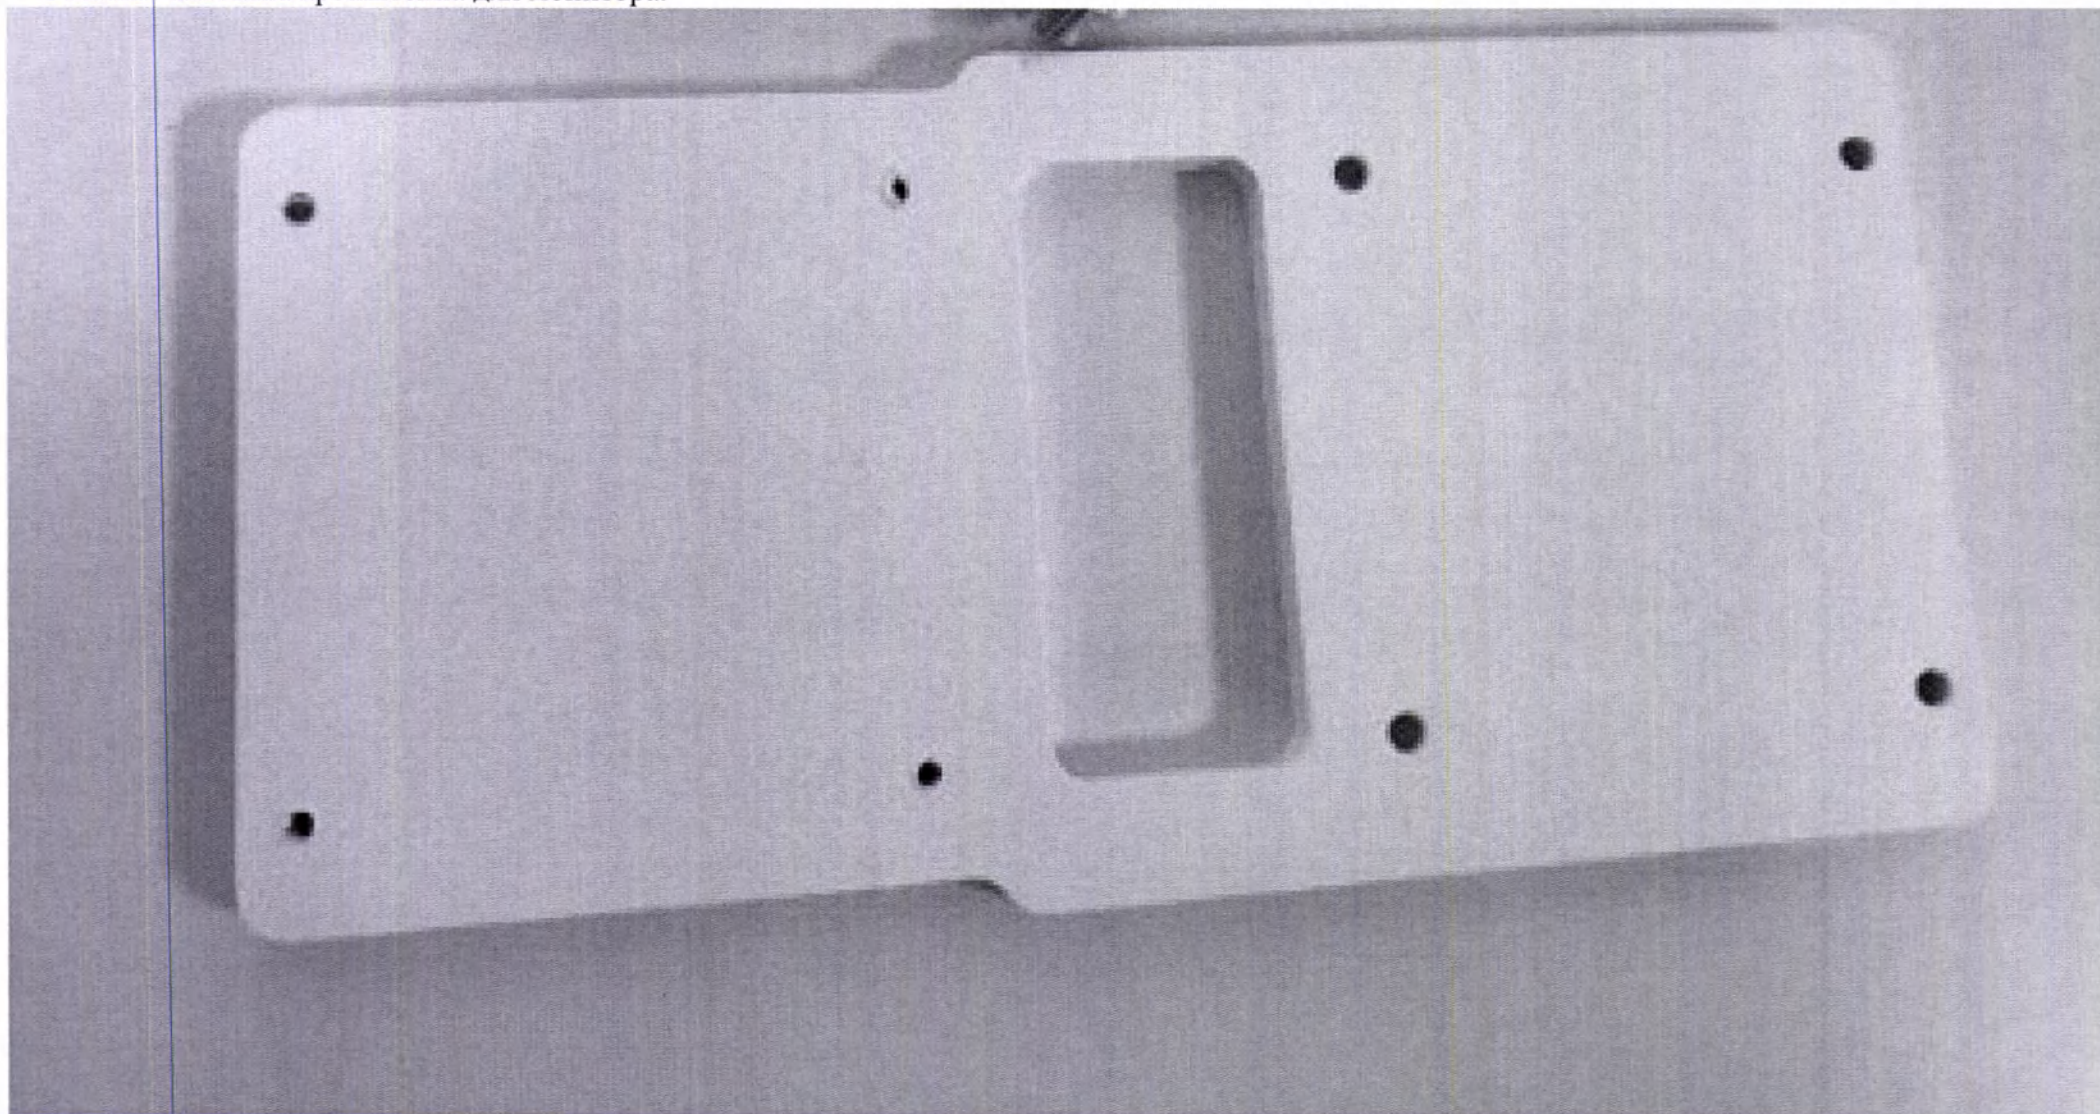


Крючок универсальный.

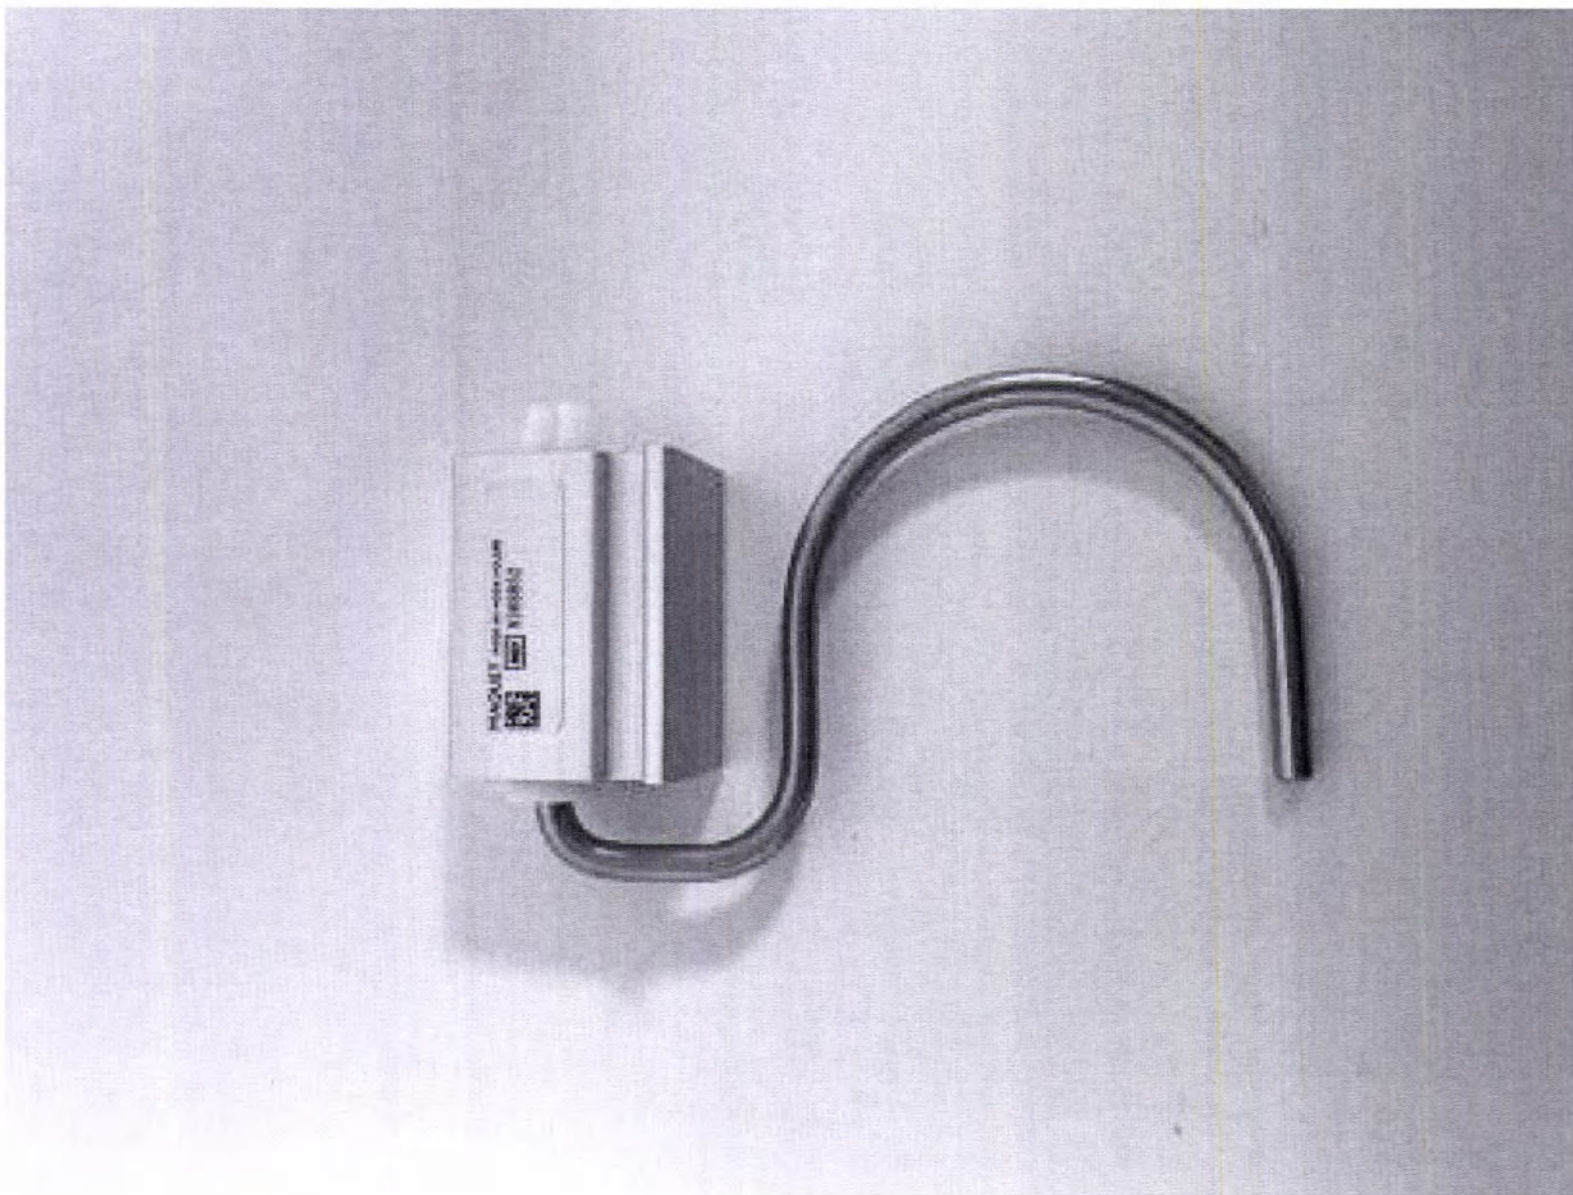

Держатель адаптера крюка.

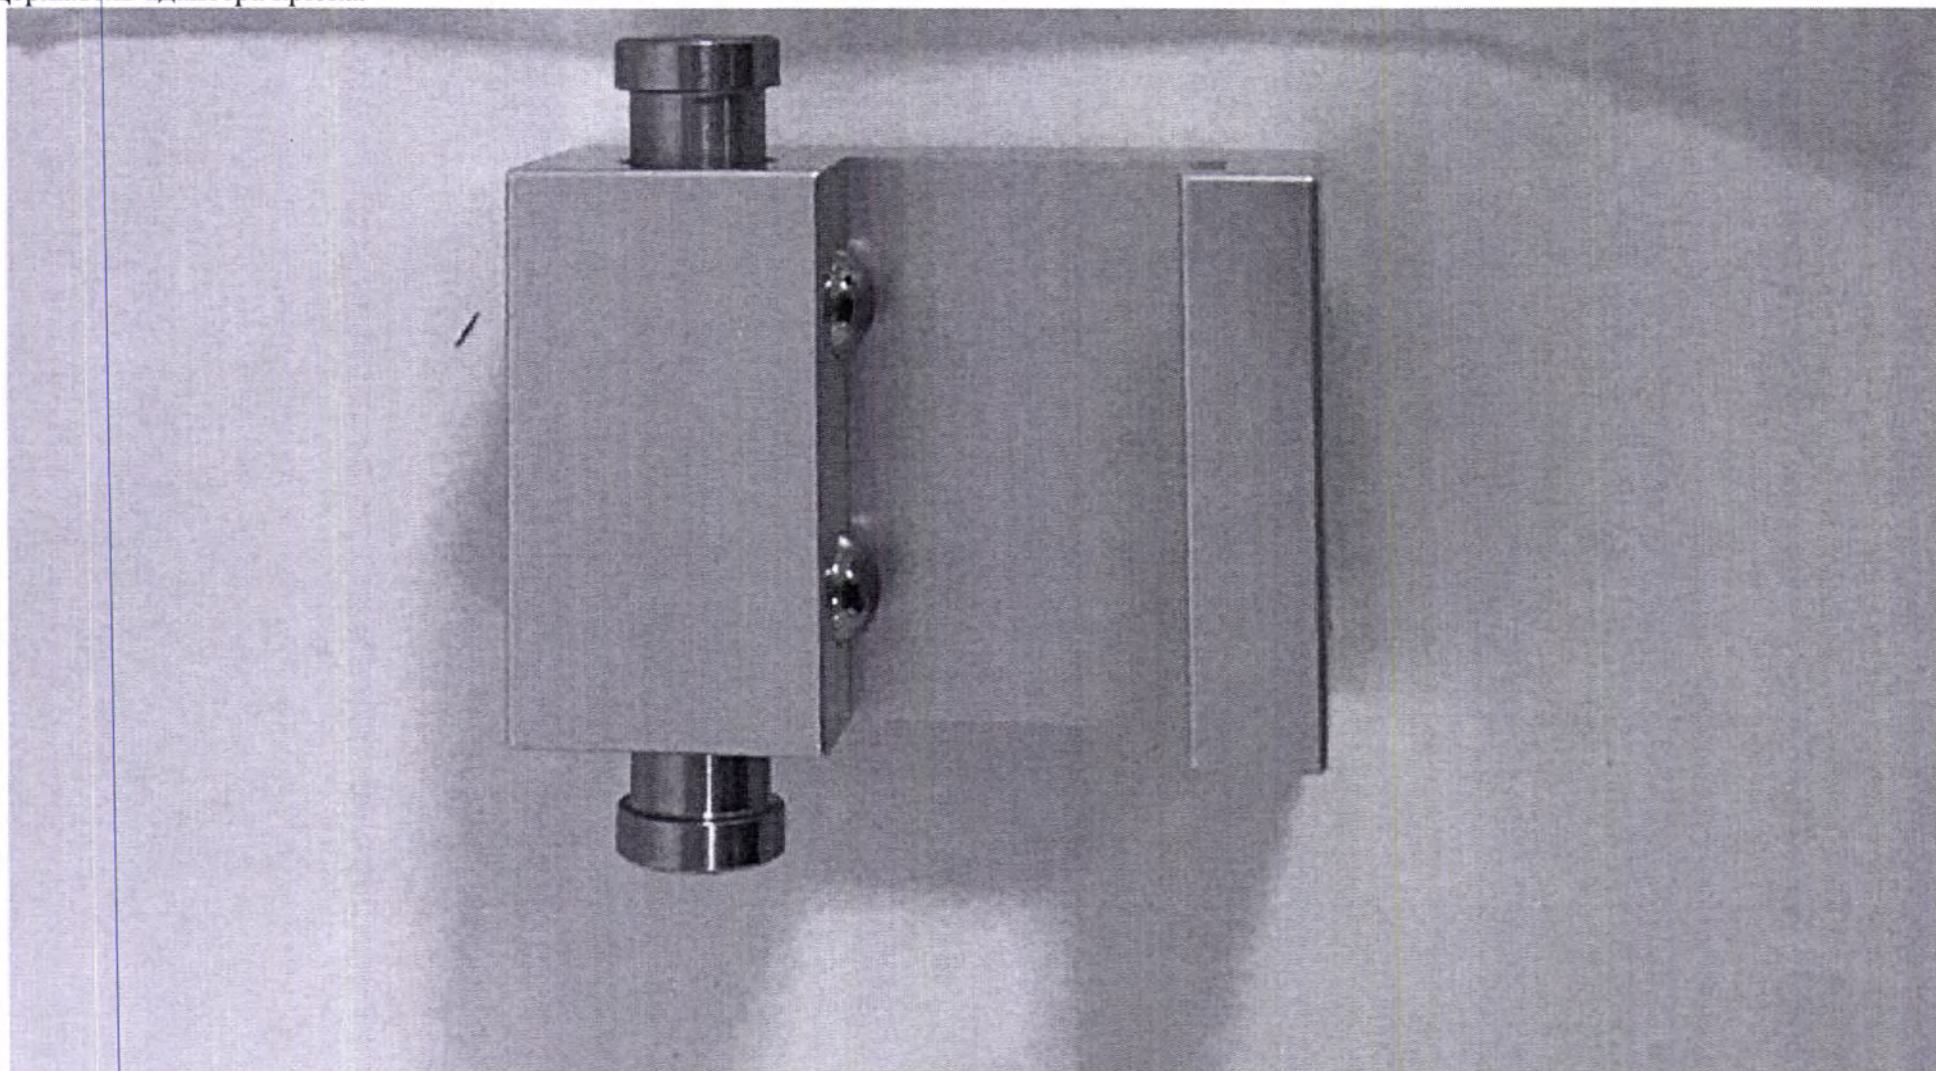


Держатель рельсы.

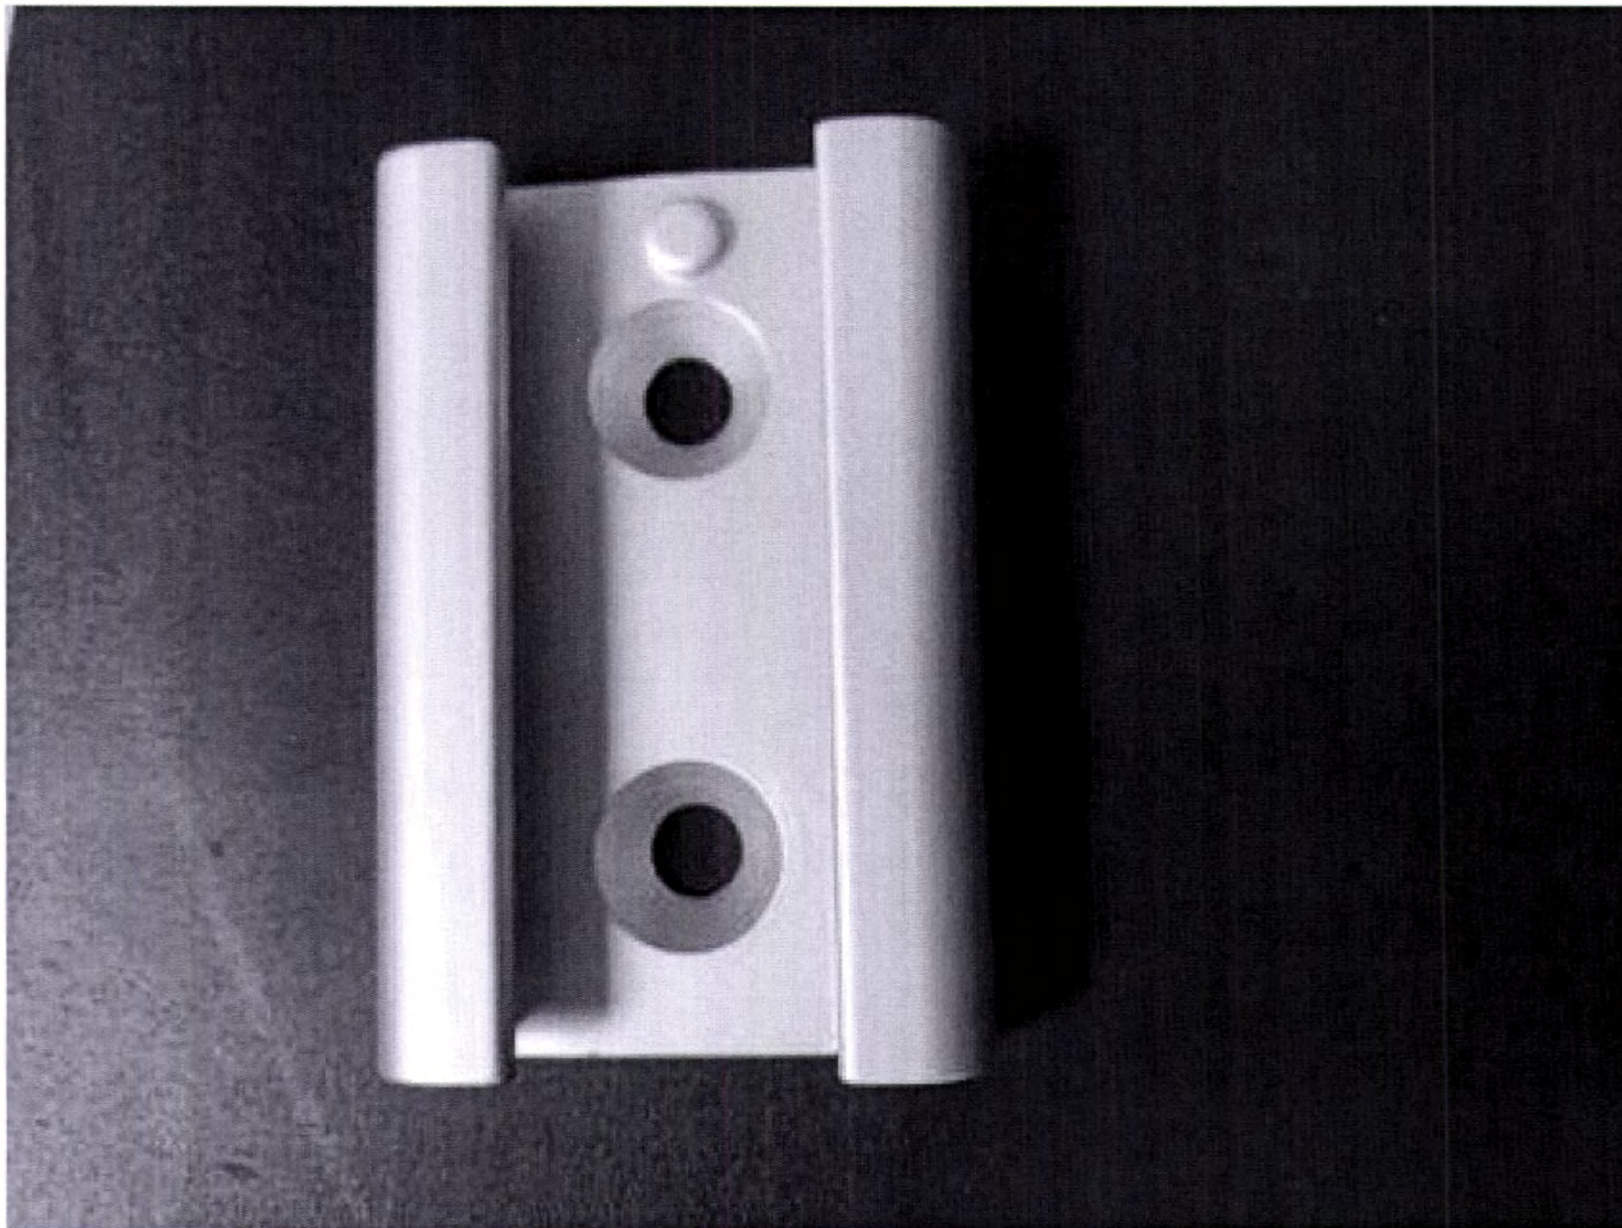


Держатель мешка для ручной вентиляции.



Держатель кабелей.

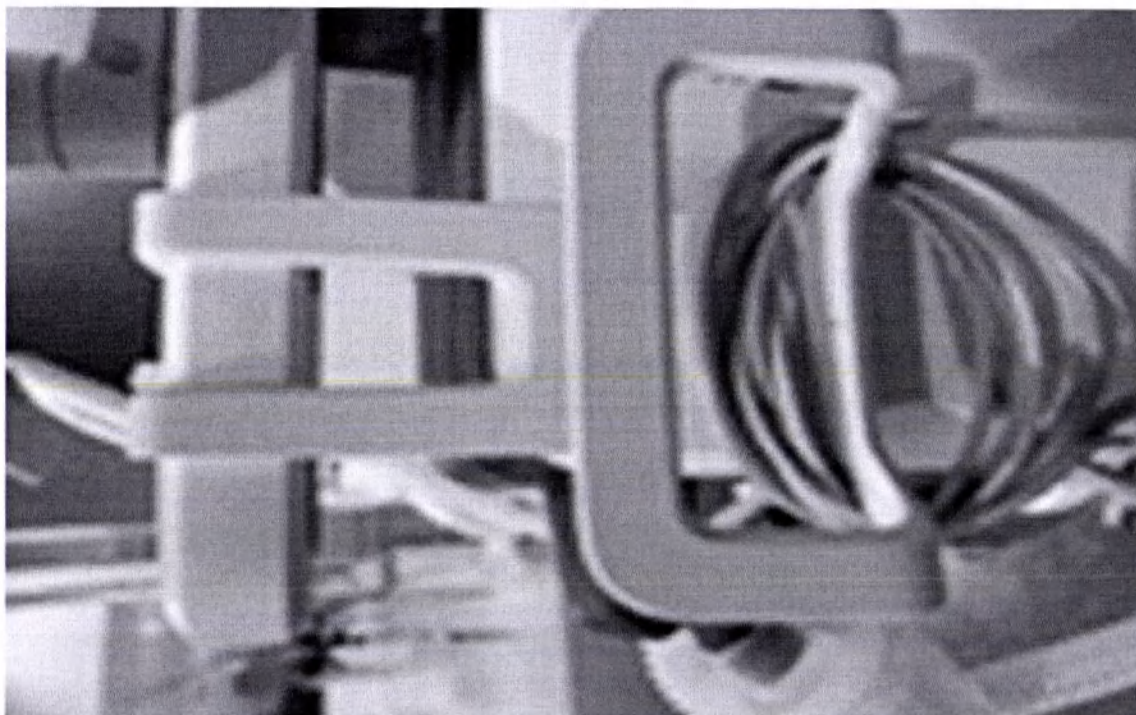


Держатель шлангов пациента.

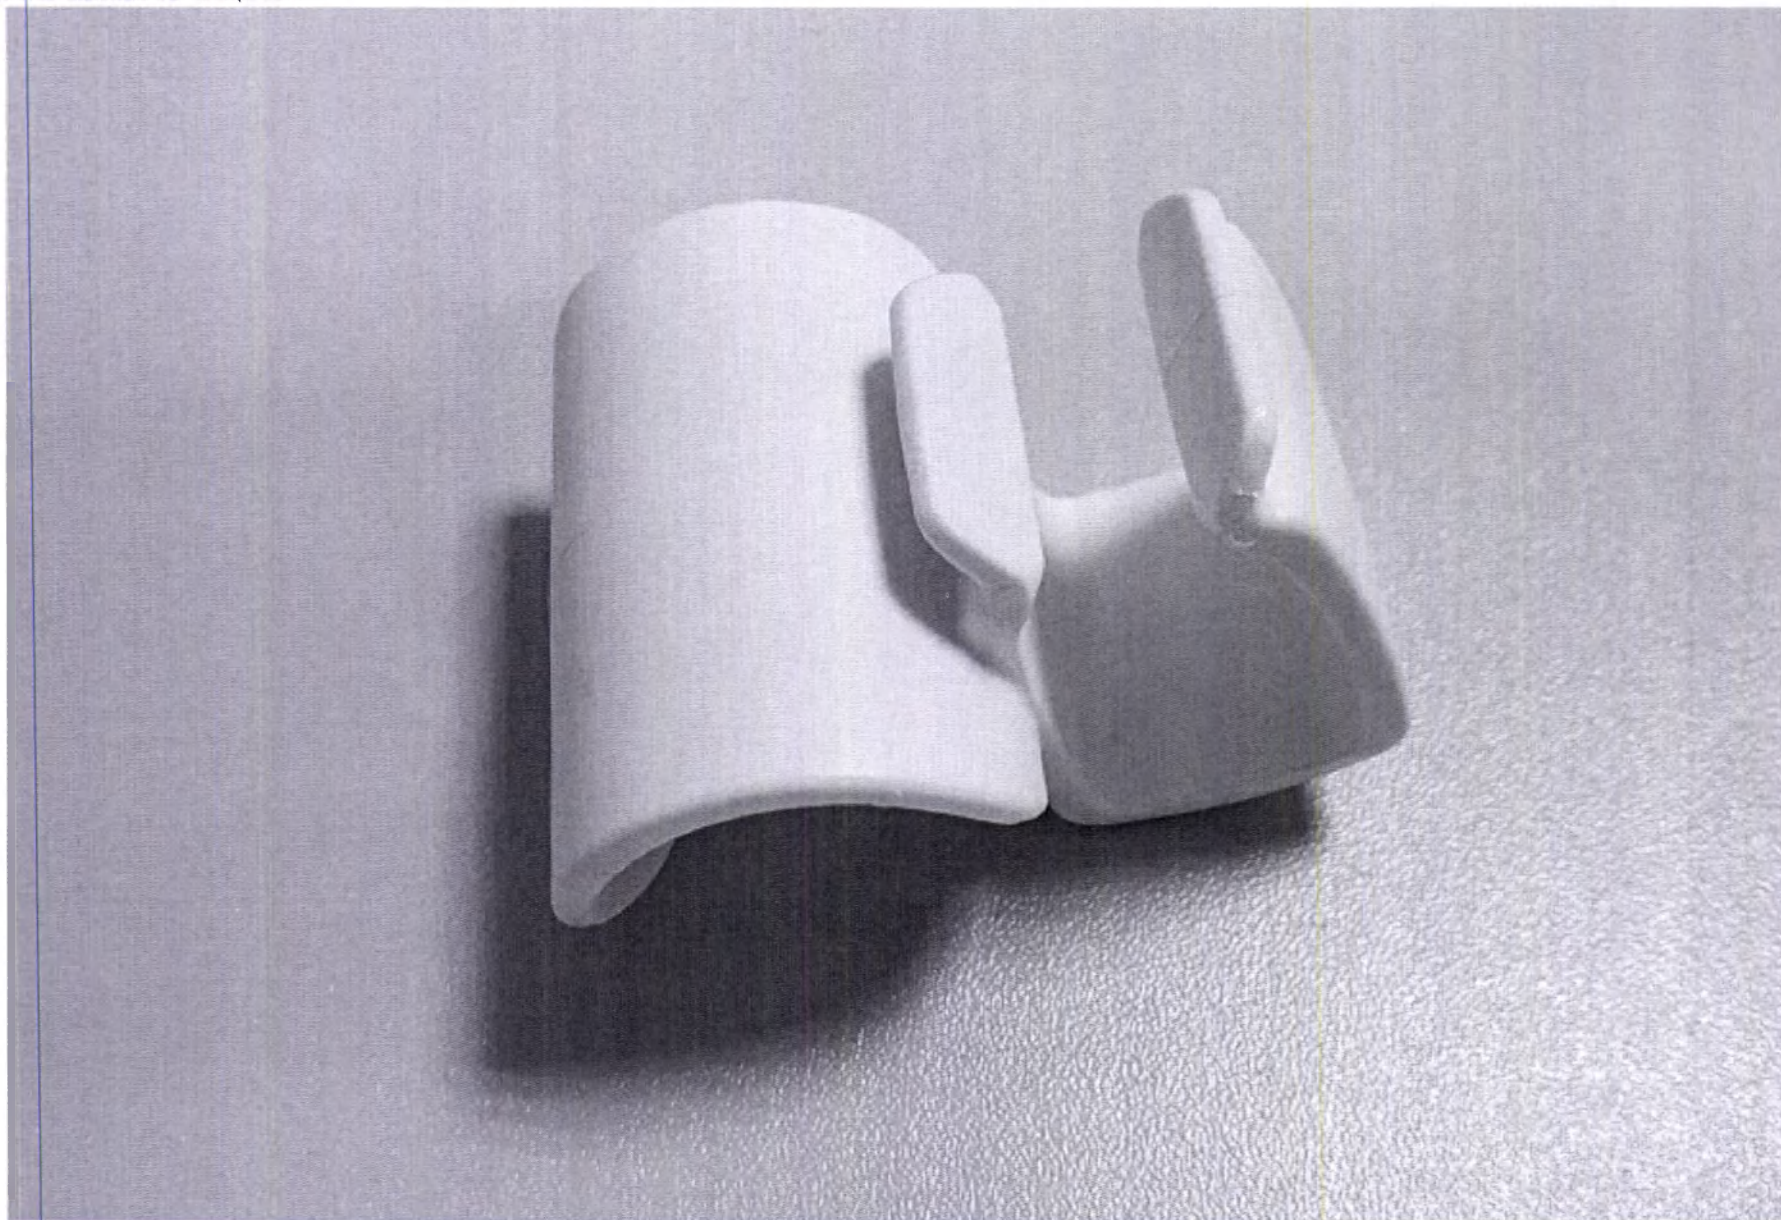


Ящик.




Вставка с замком в ящик.

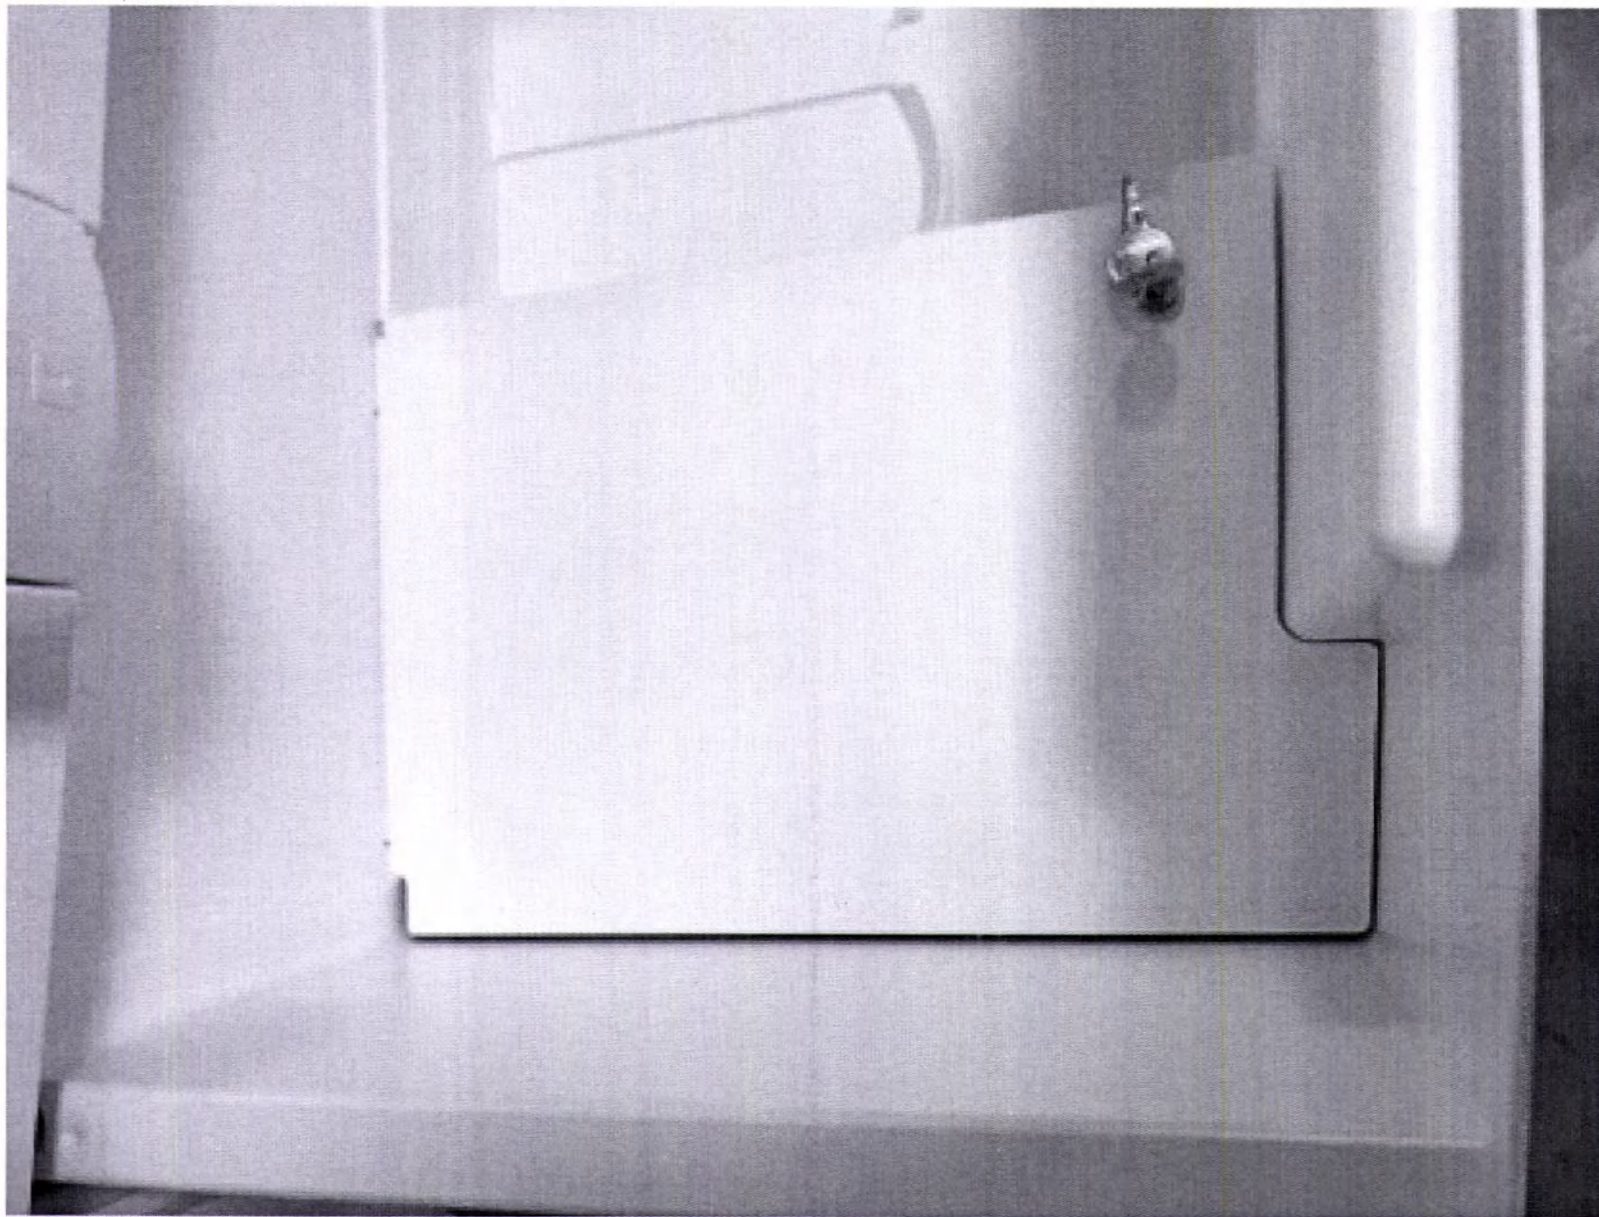

Разделитель для ящика.

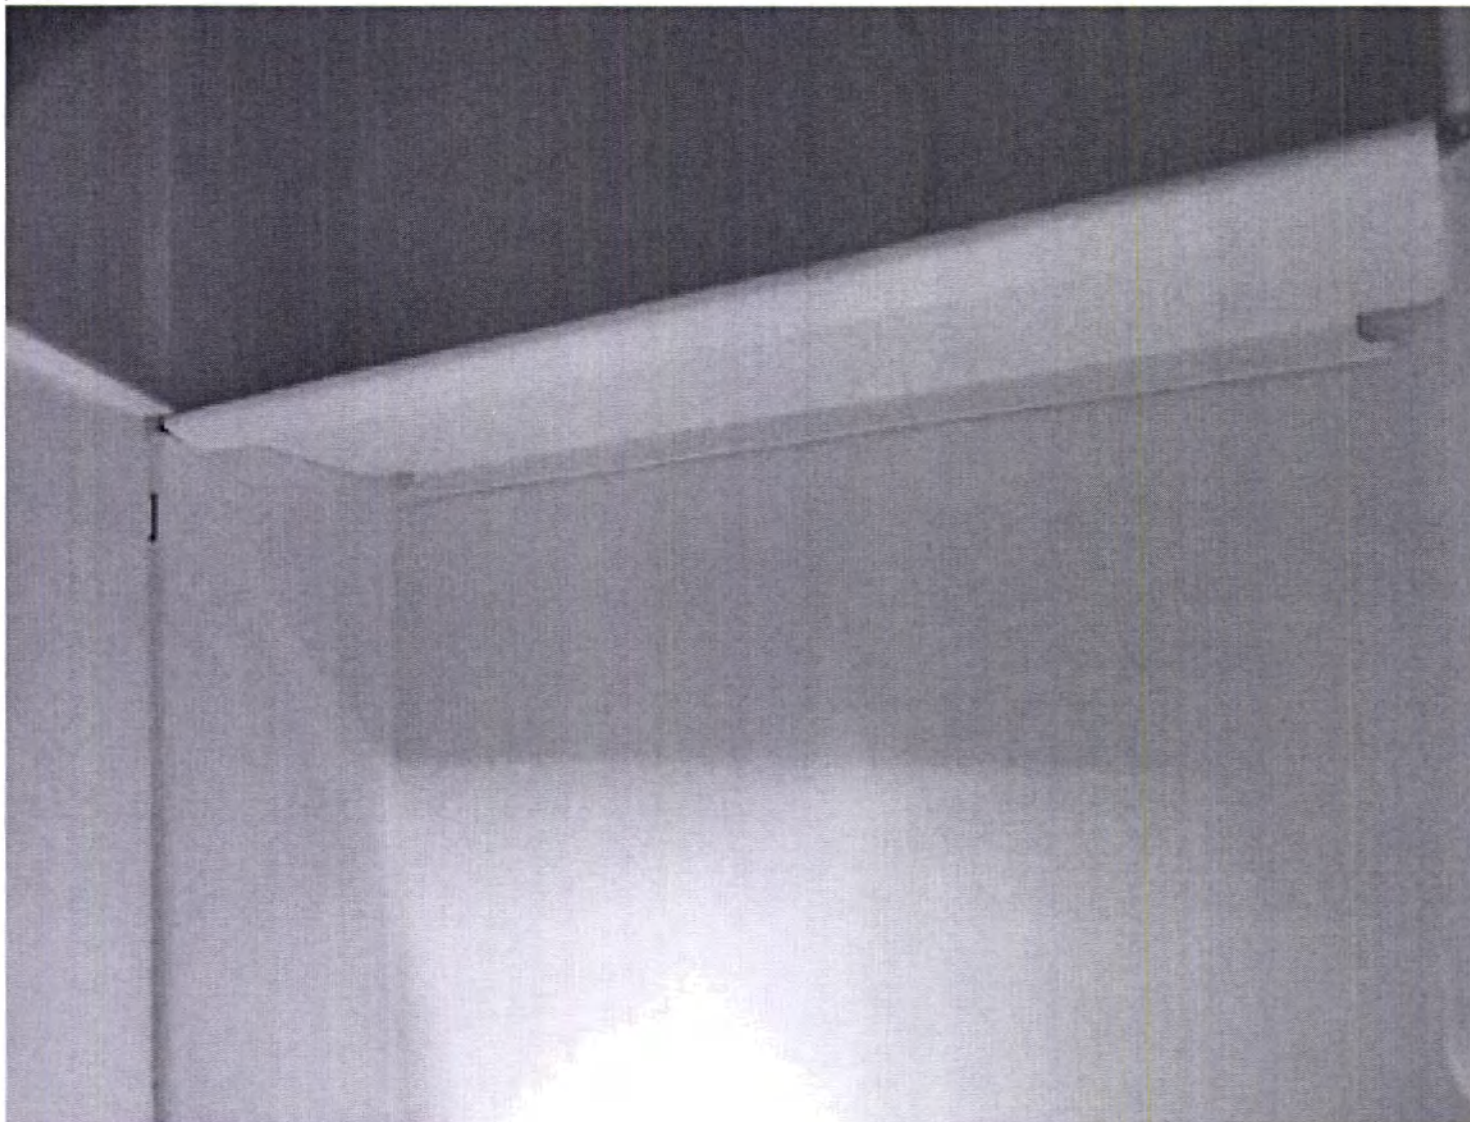


Набор адаптеров для очистки кассеты пациента.

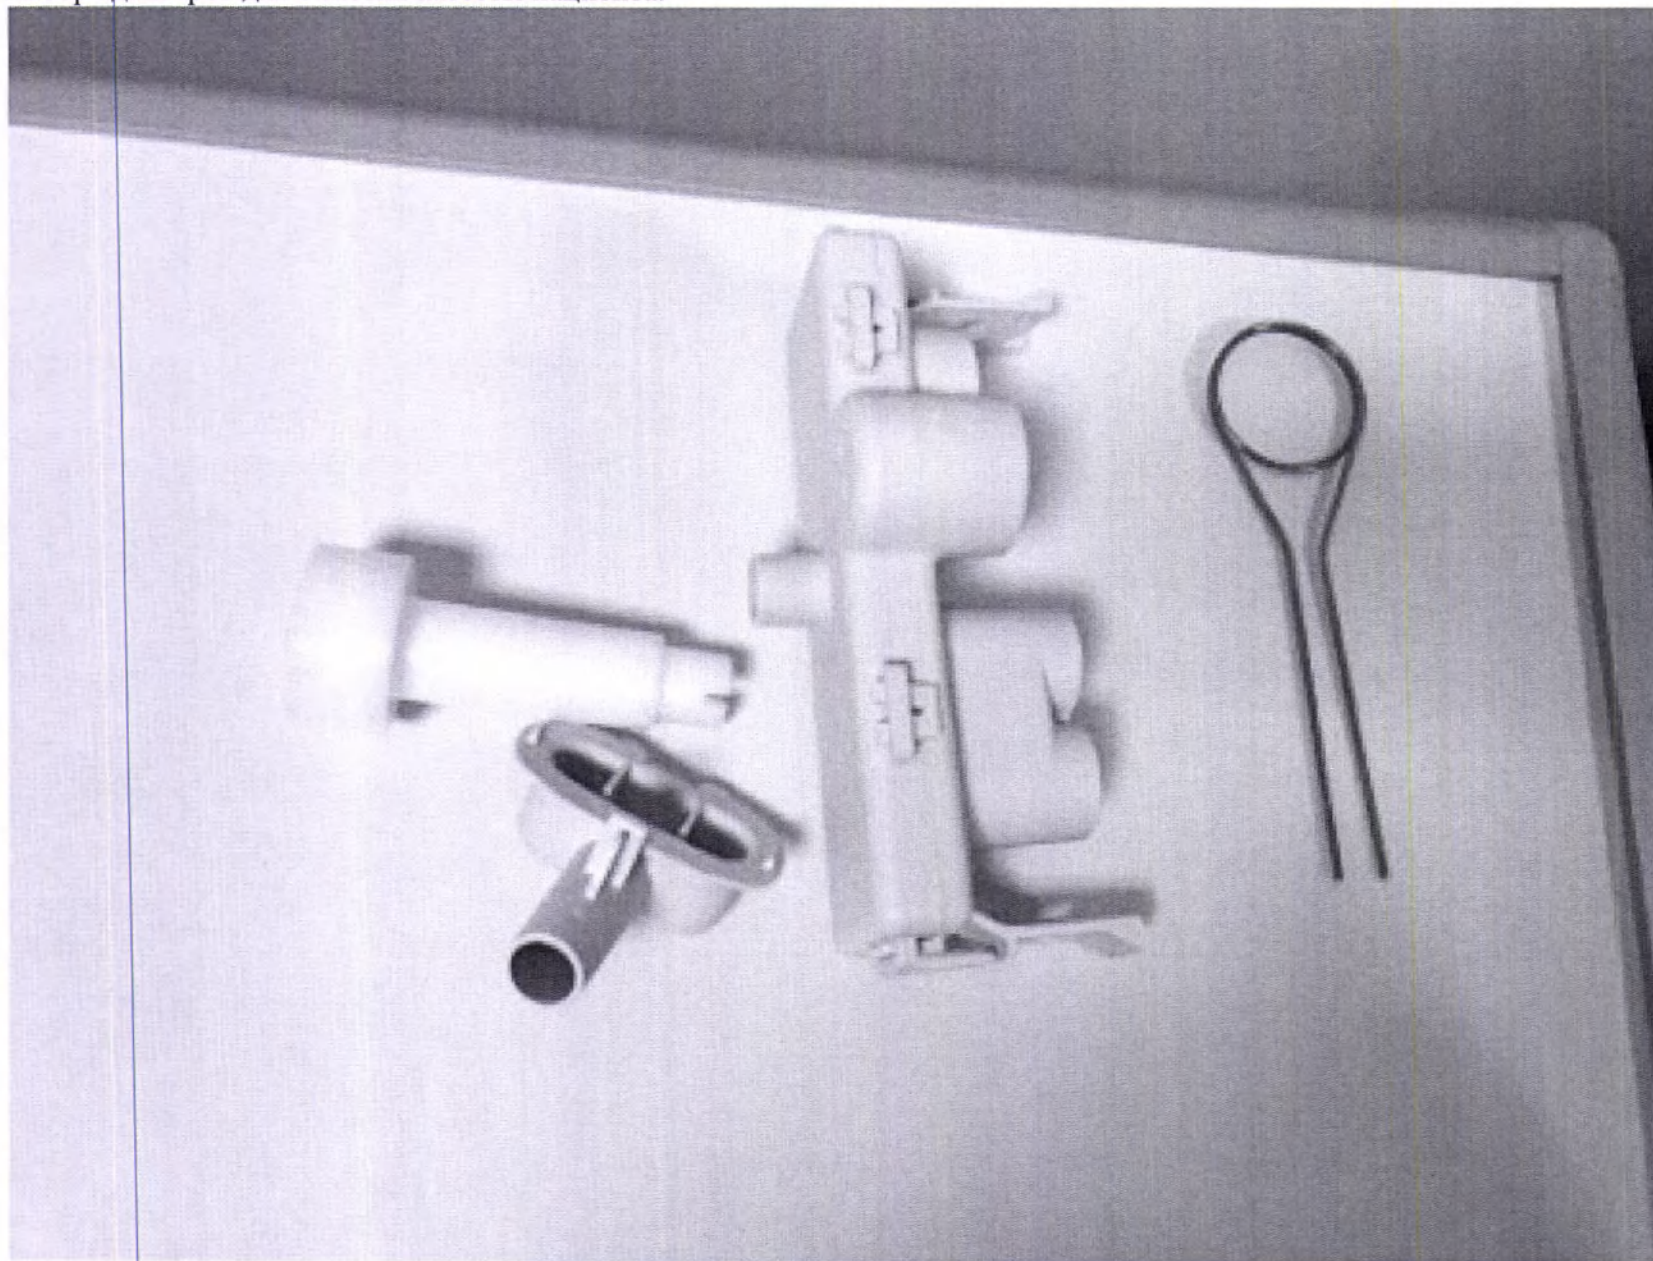

Испаритель для изофлюрана.




Испаритель для севофлюрана.

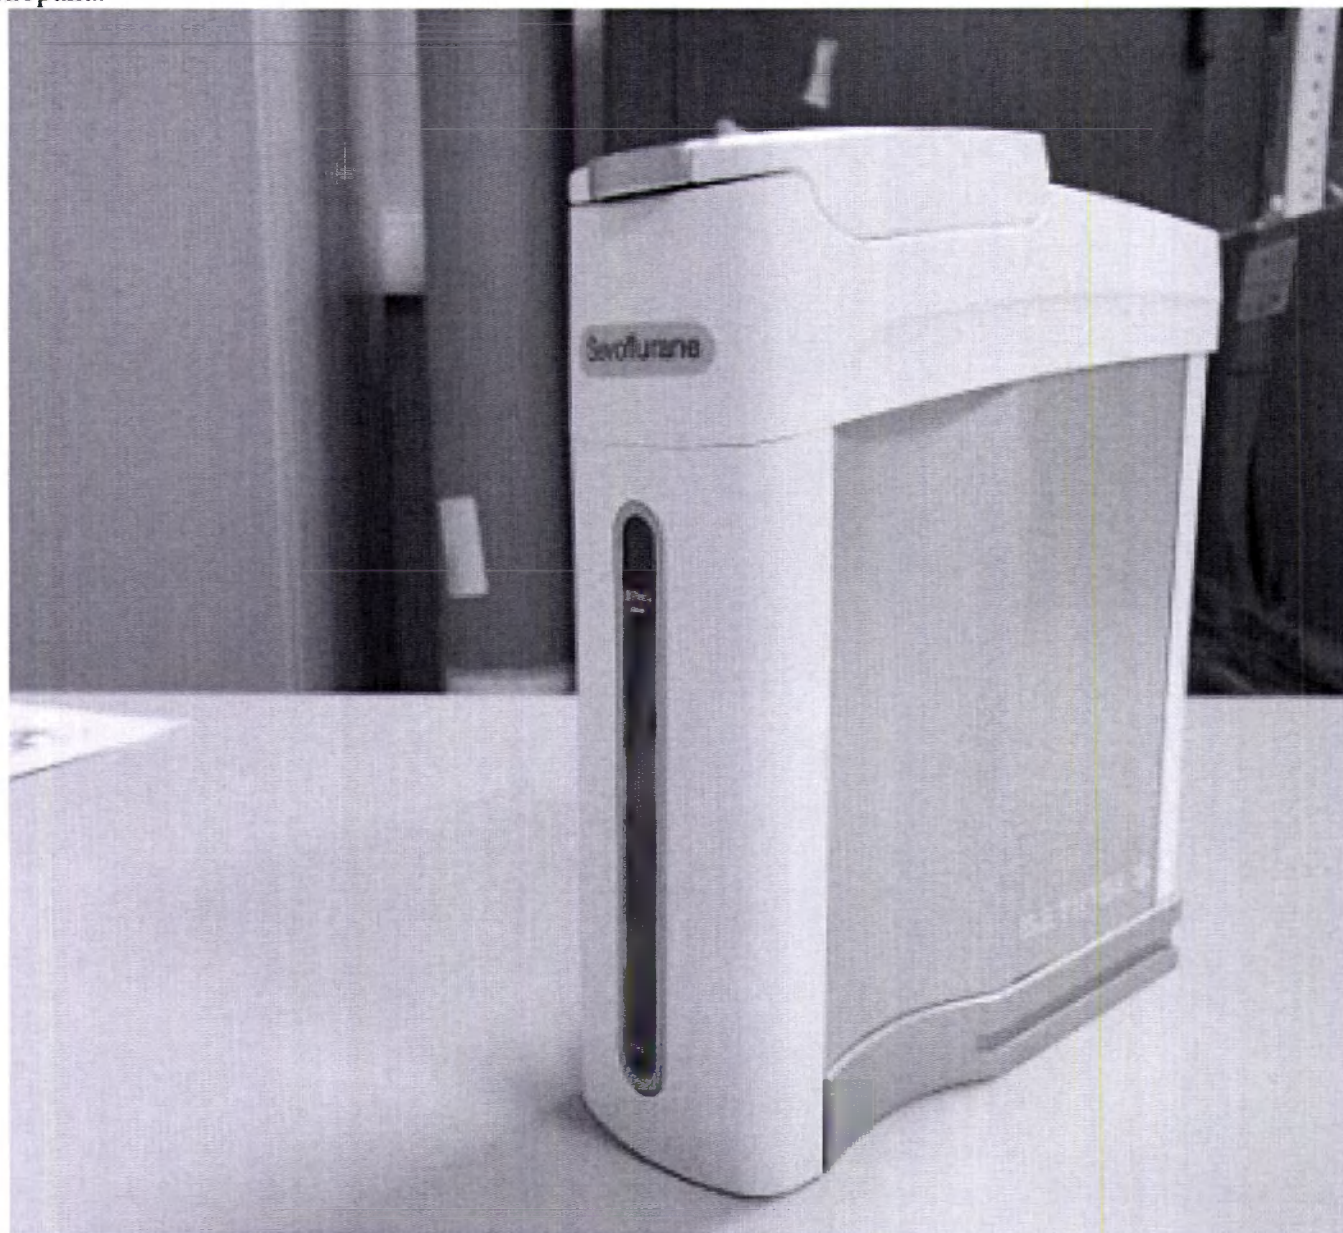


Испаритель для десфлюрана.




Адаптер для флакона с анестезирующим агентом.

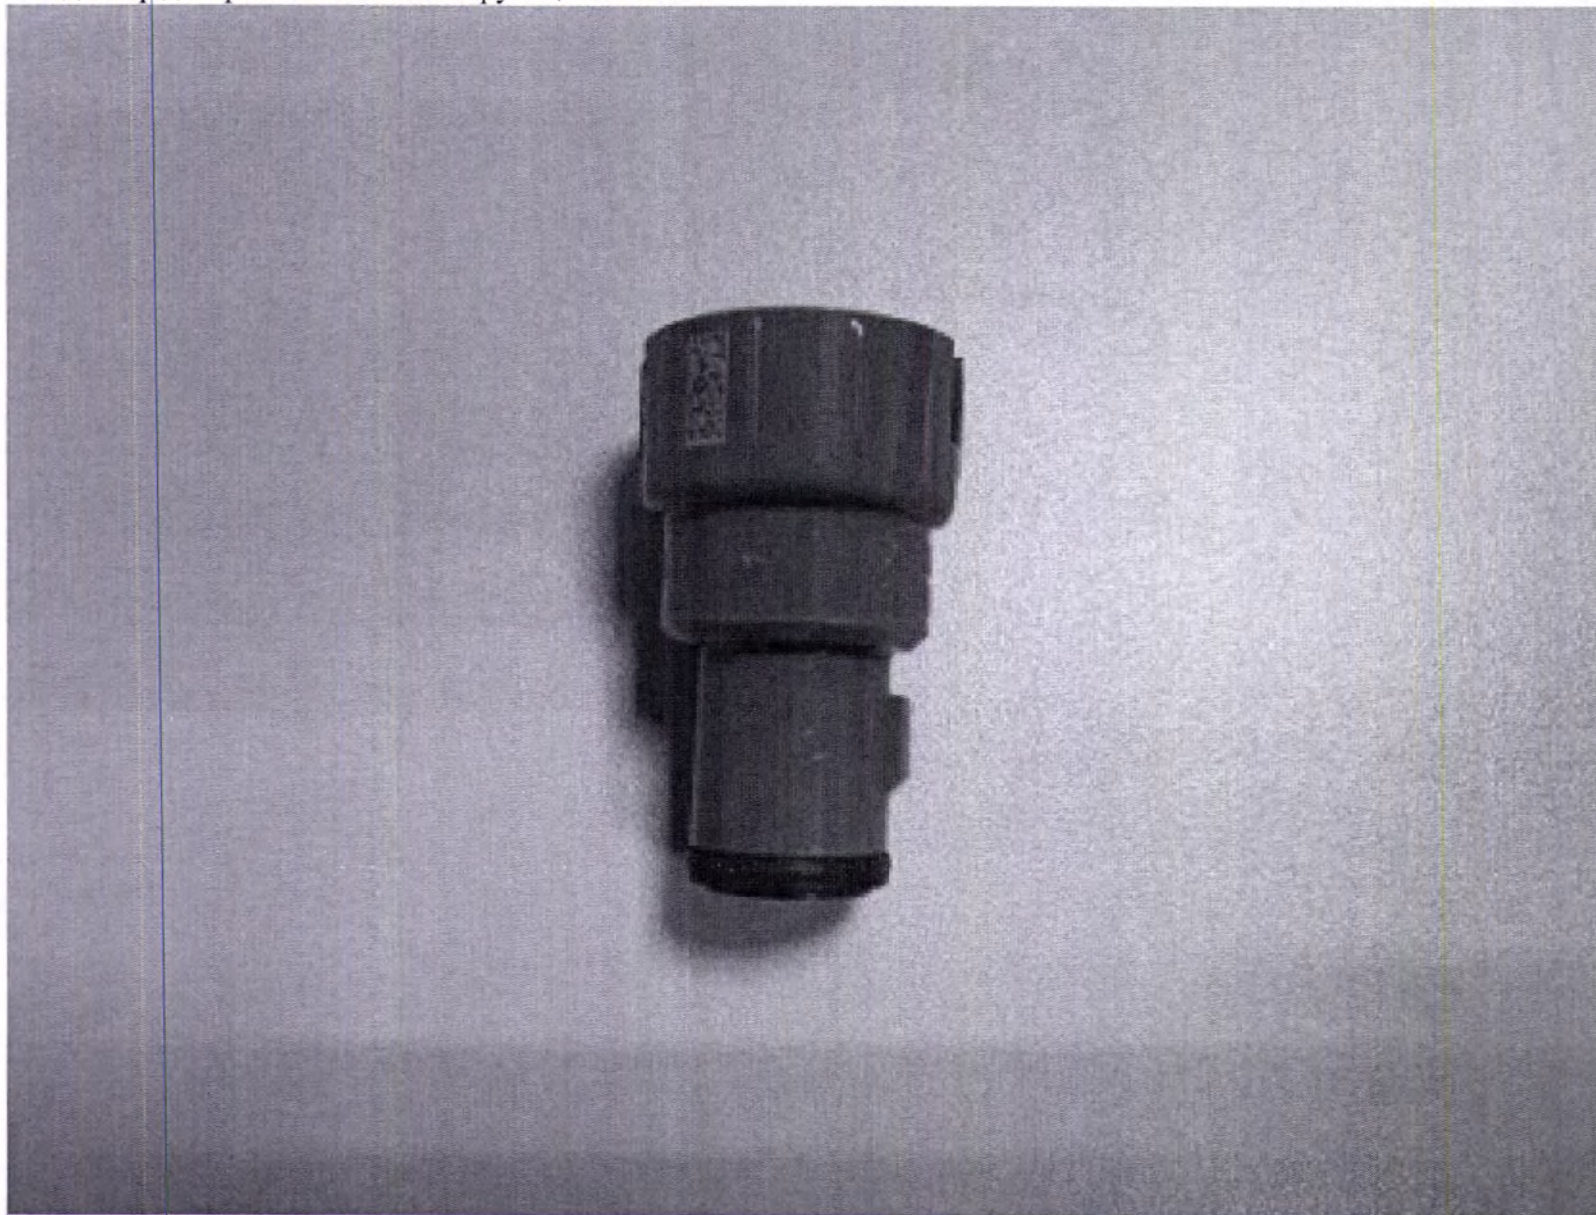

Абсорбер углекислого газа, одноразовый.

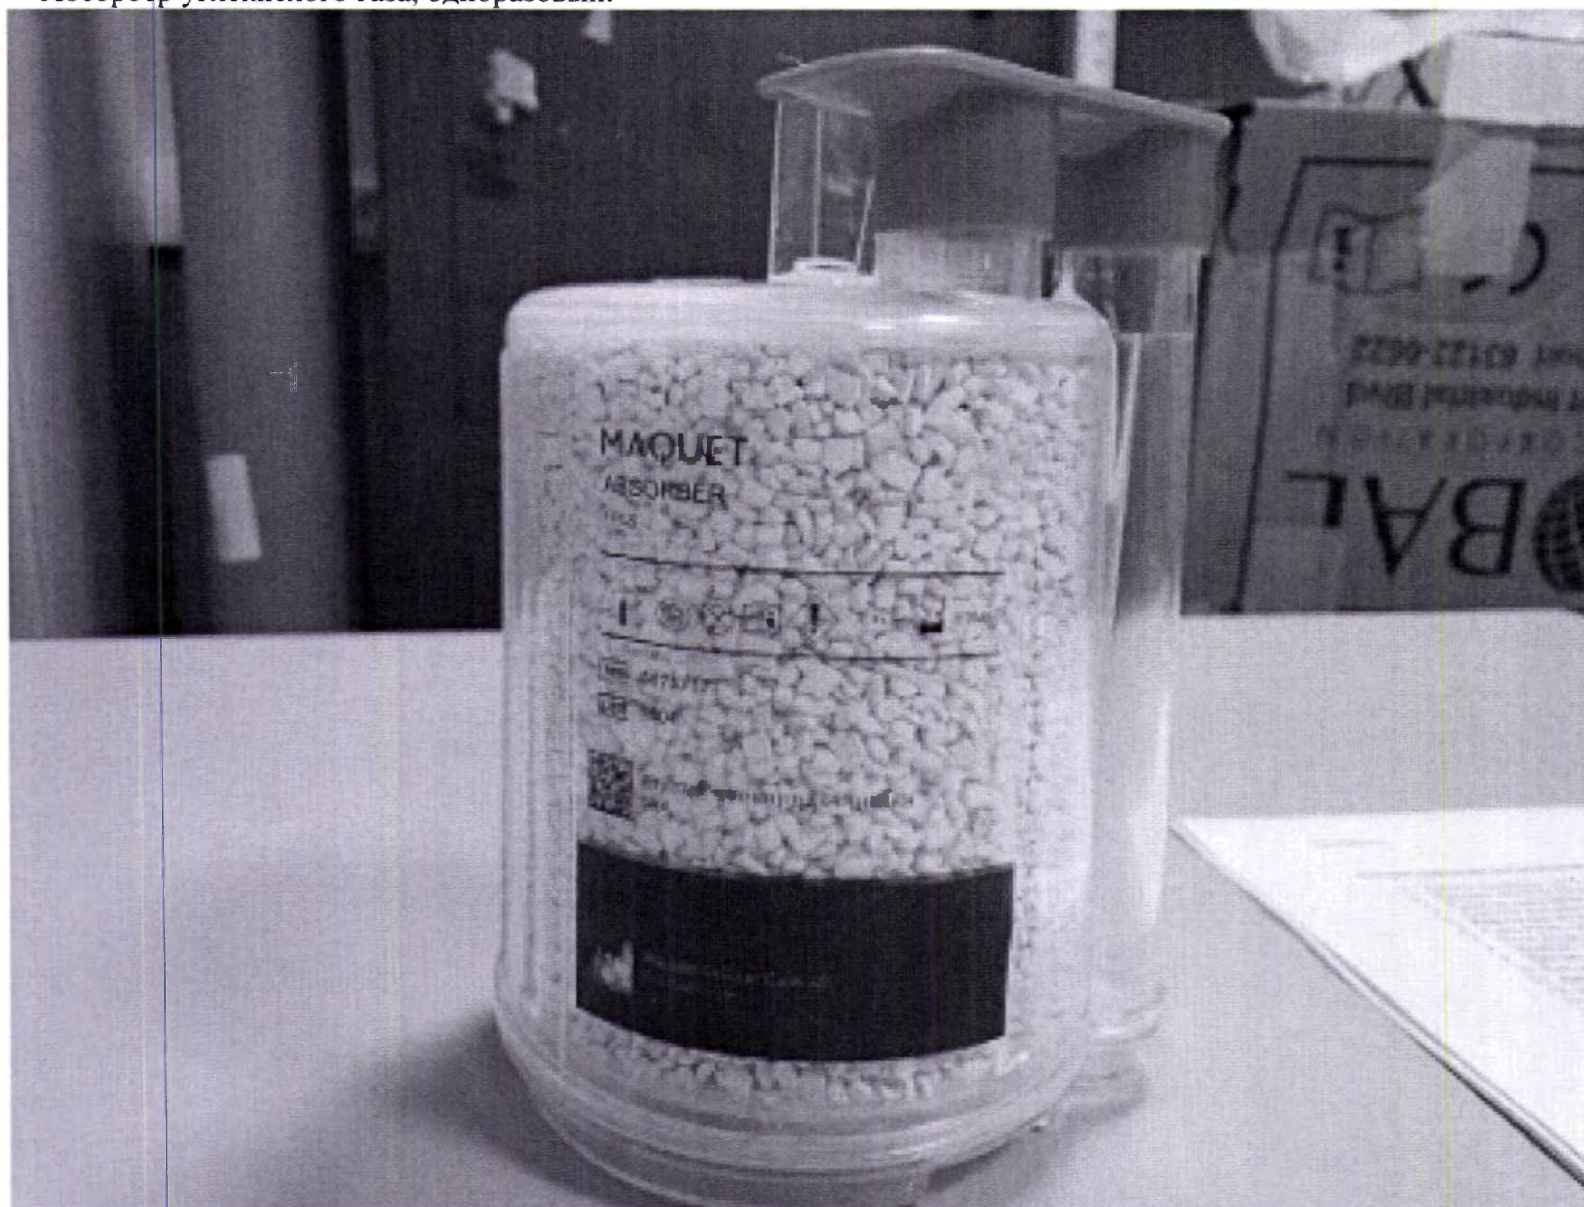


Ёмкость абсорбера углекислого газа, многоразовая.

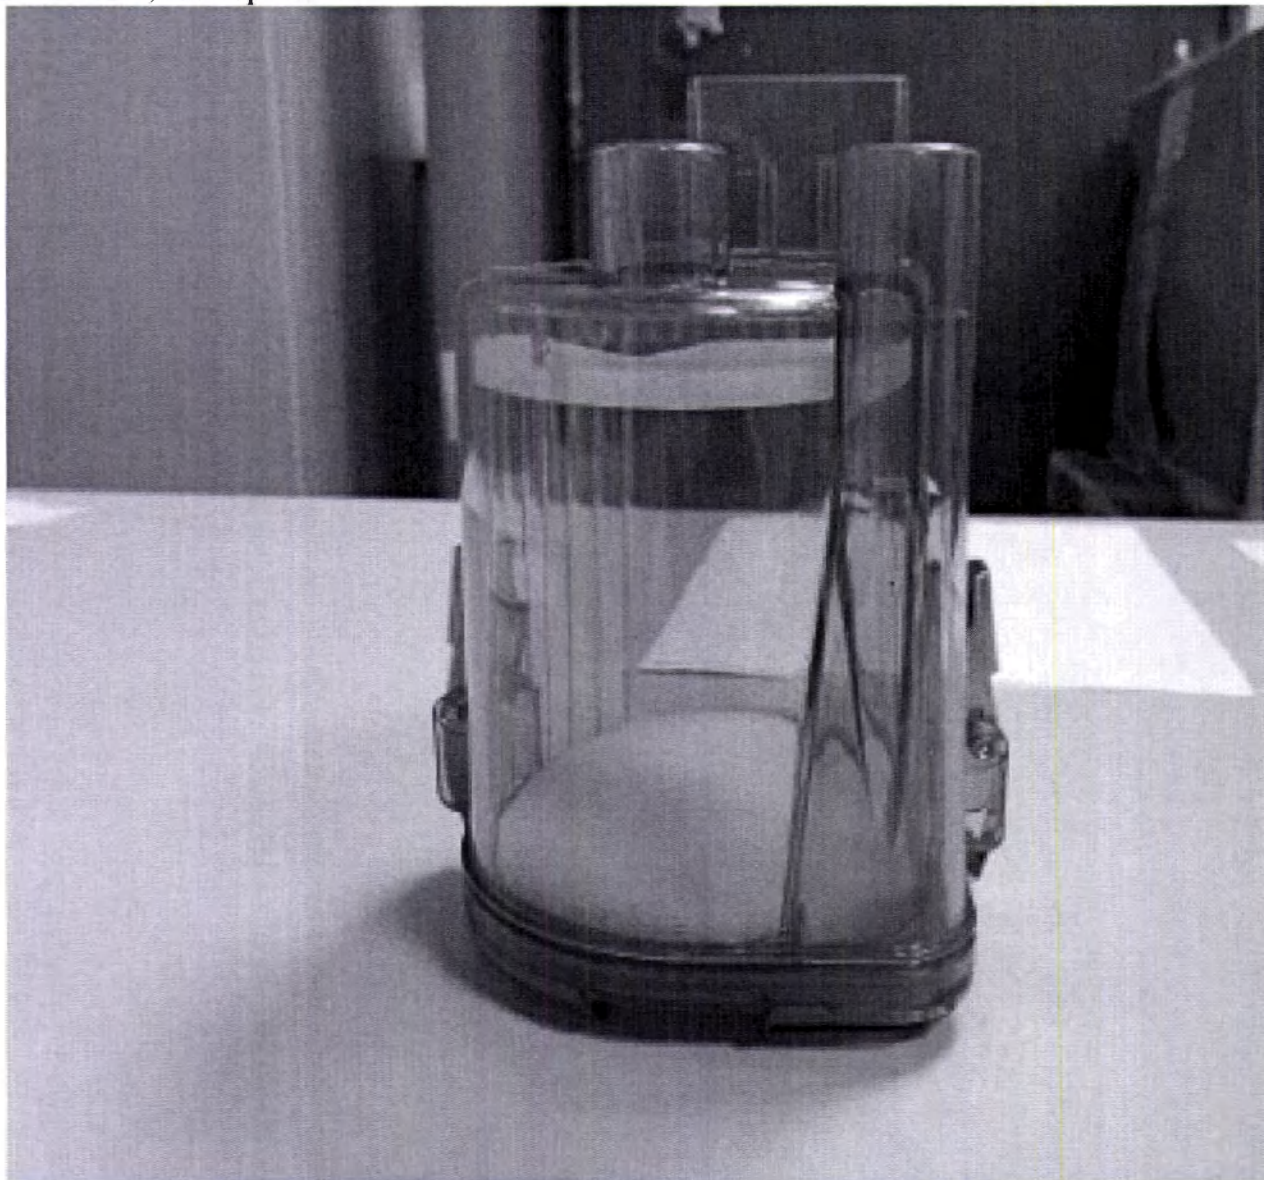


Фильтр для ёмкости абсорбера углекислого газа.




Блок отсасывания.

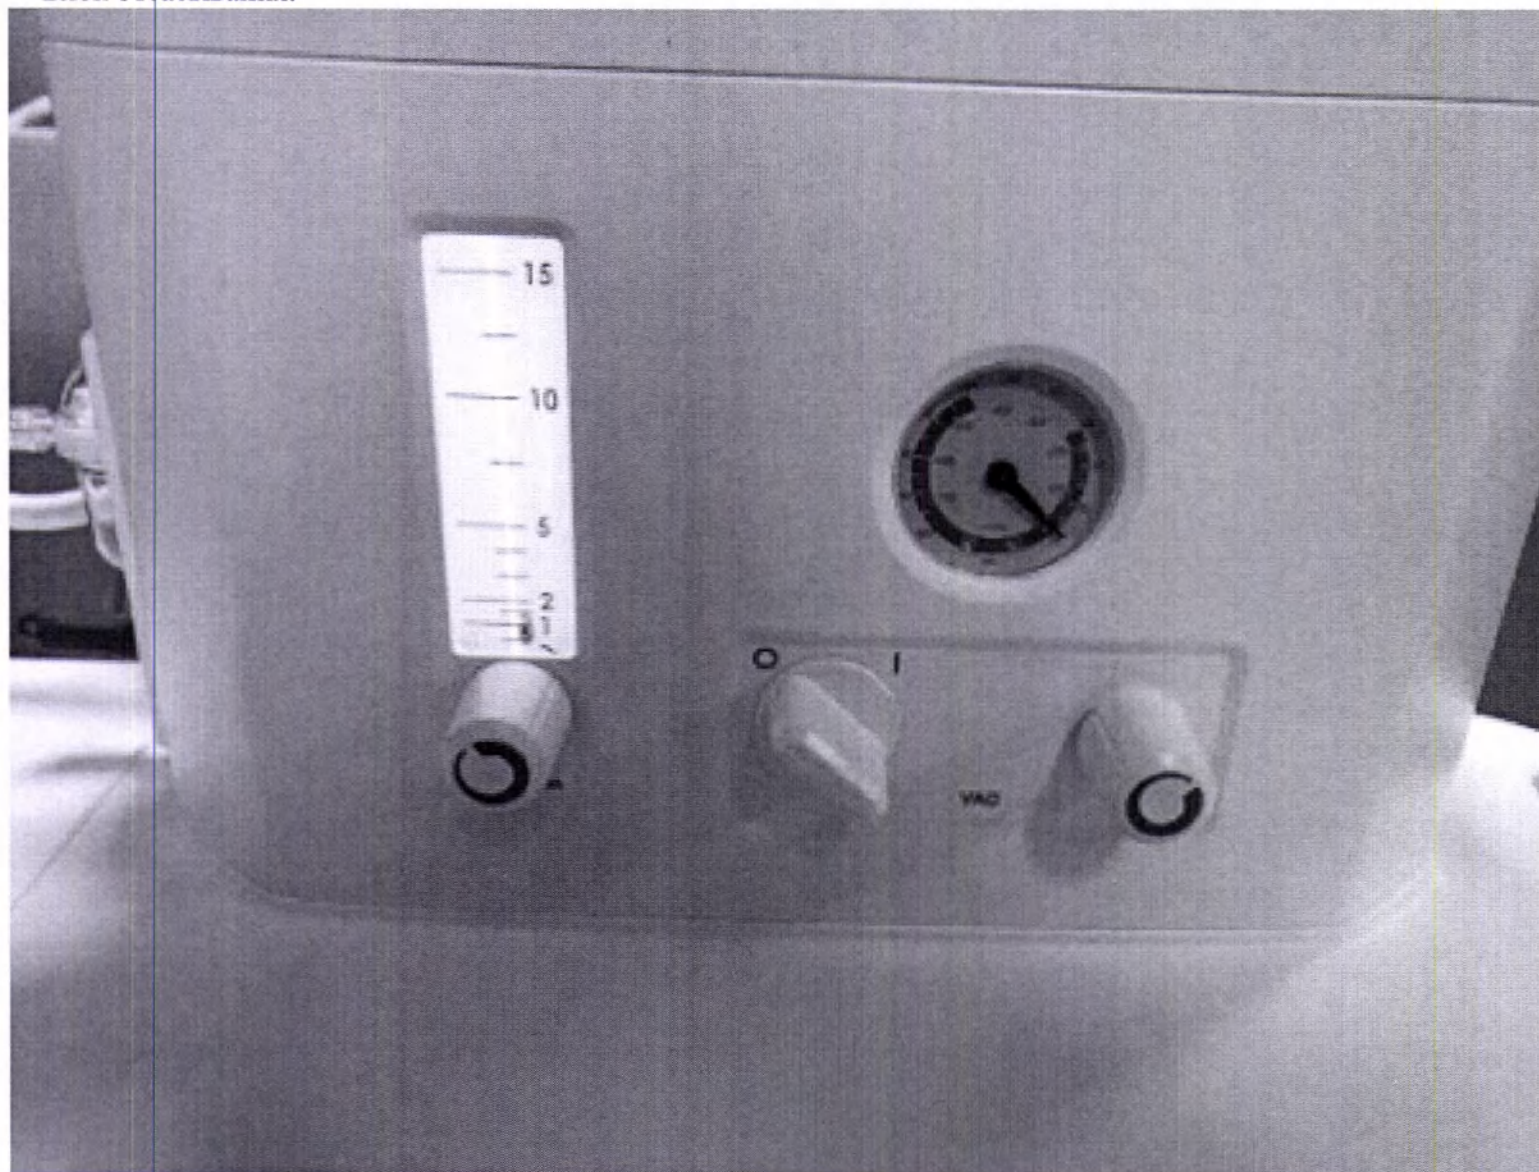


Фильтр гидрофобный бактериальный.

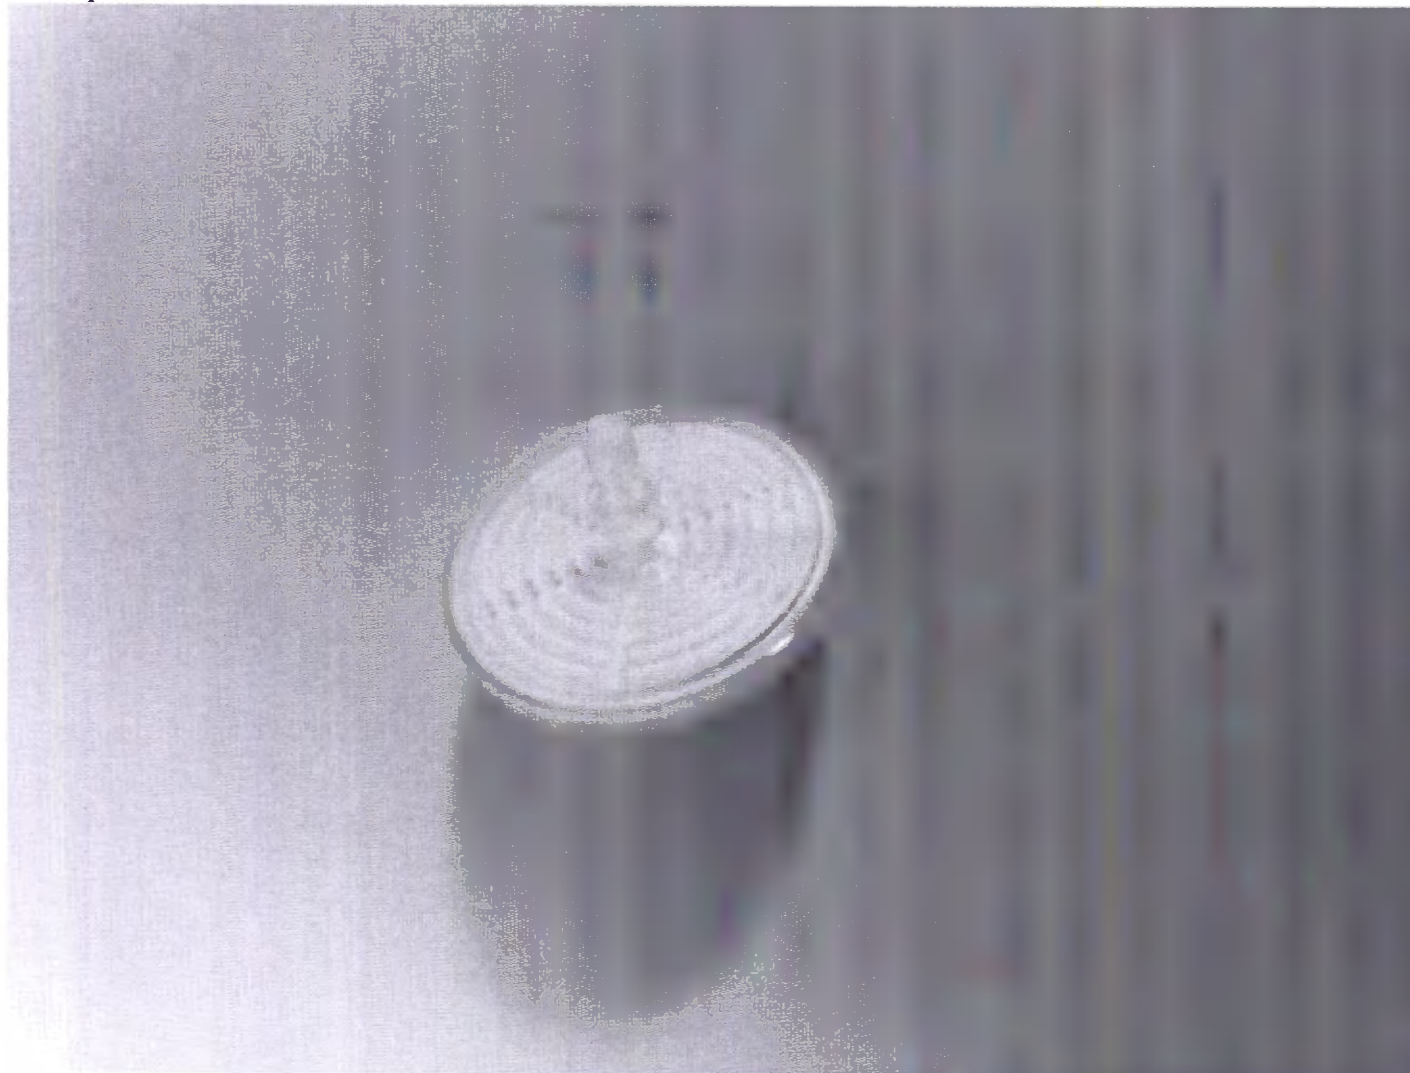


Фильтр вентилятора охлаждения.

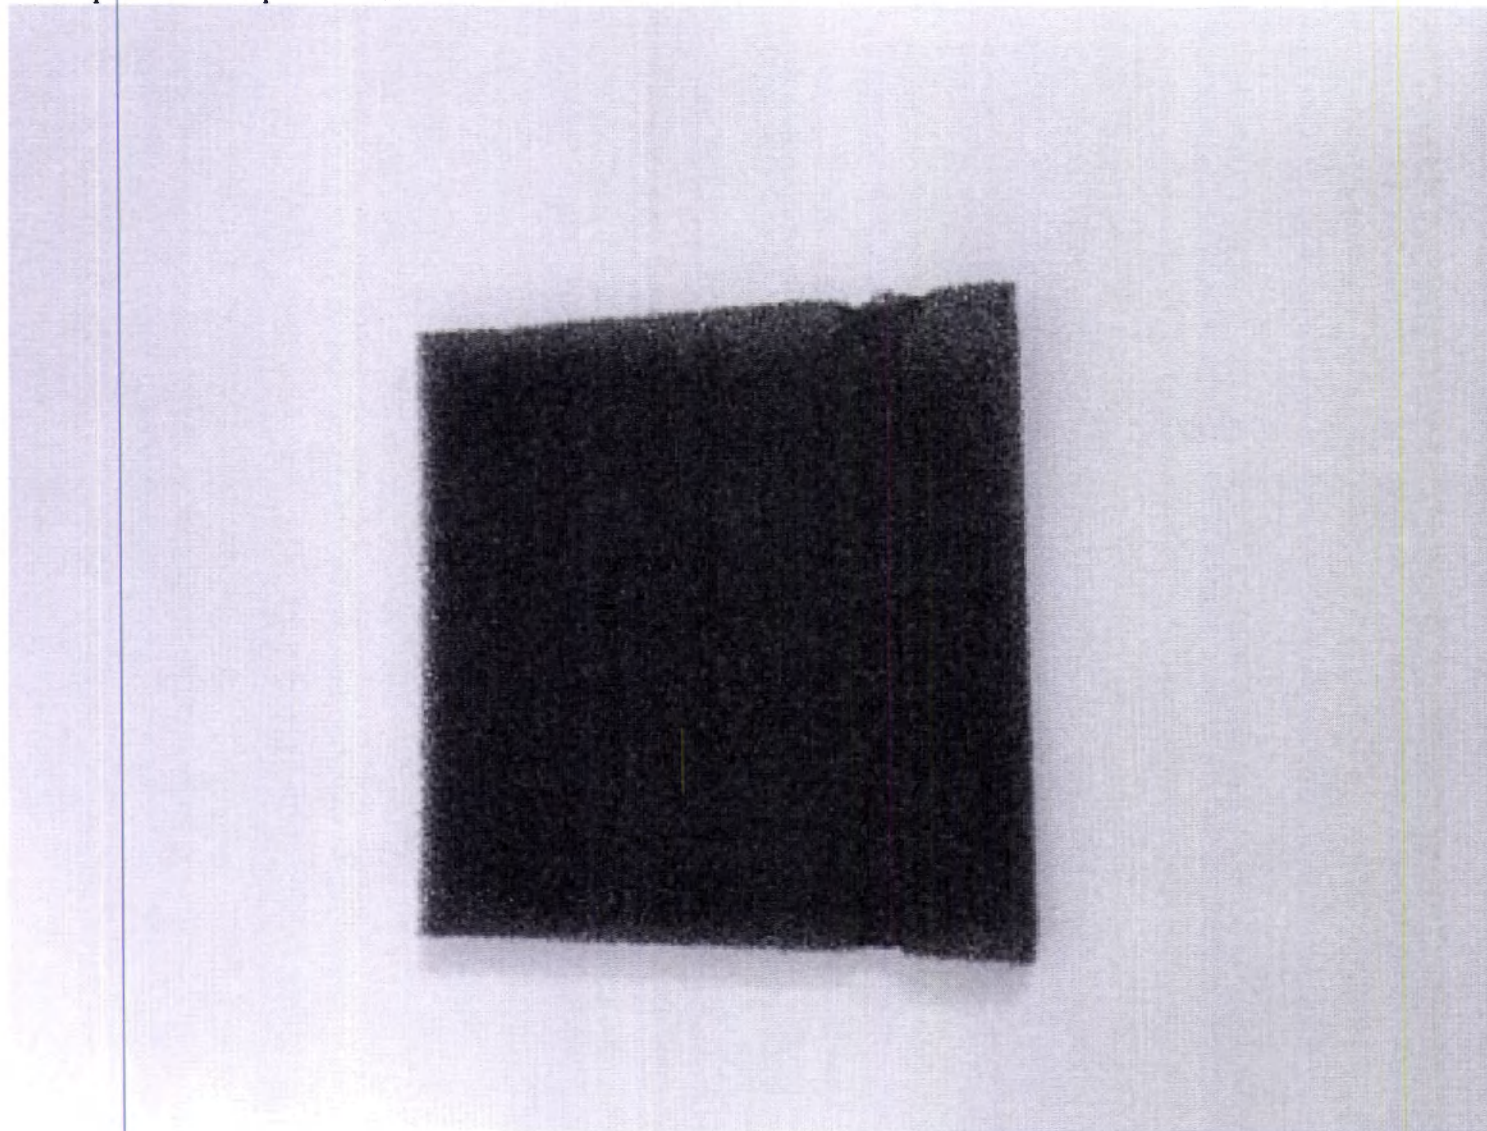


Шланг воздушный для компрессора.

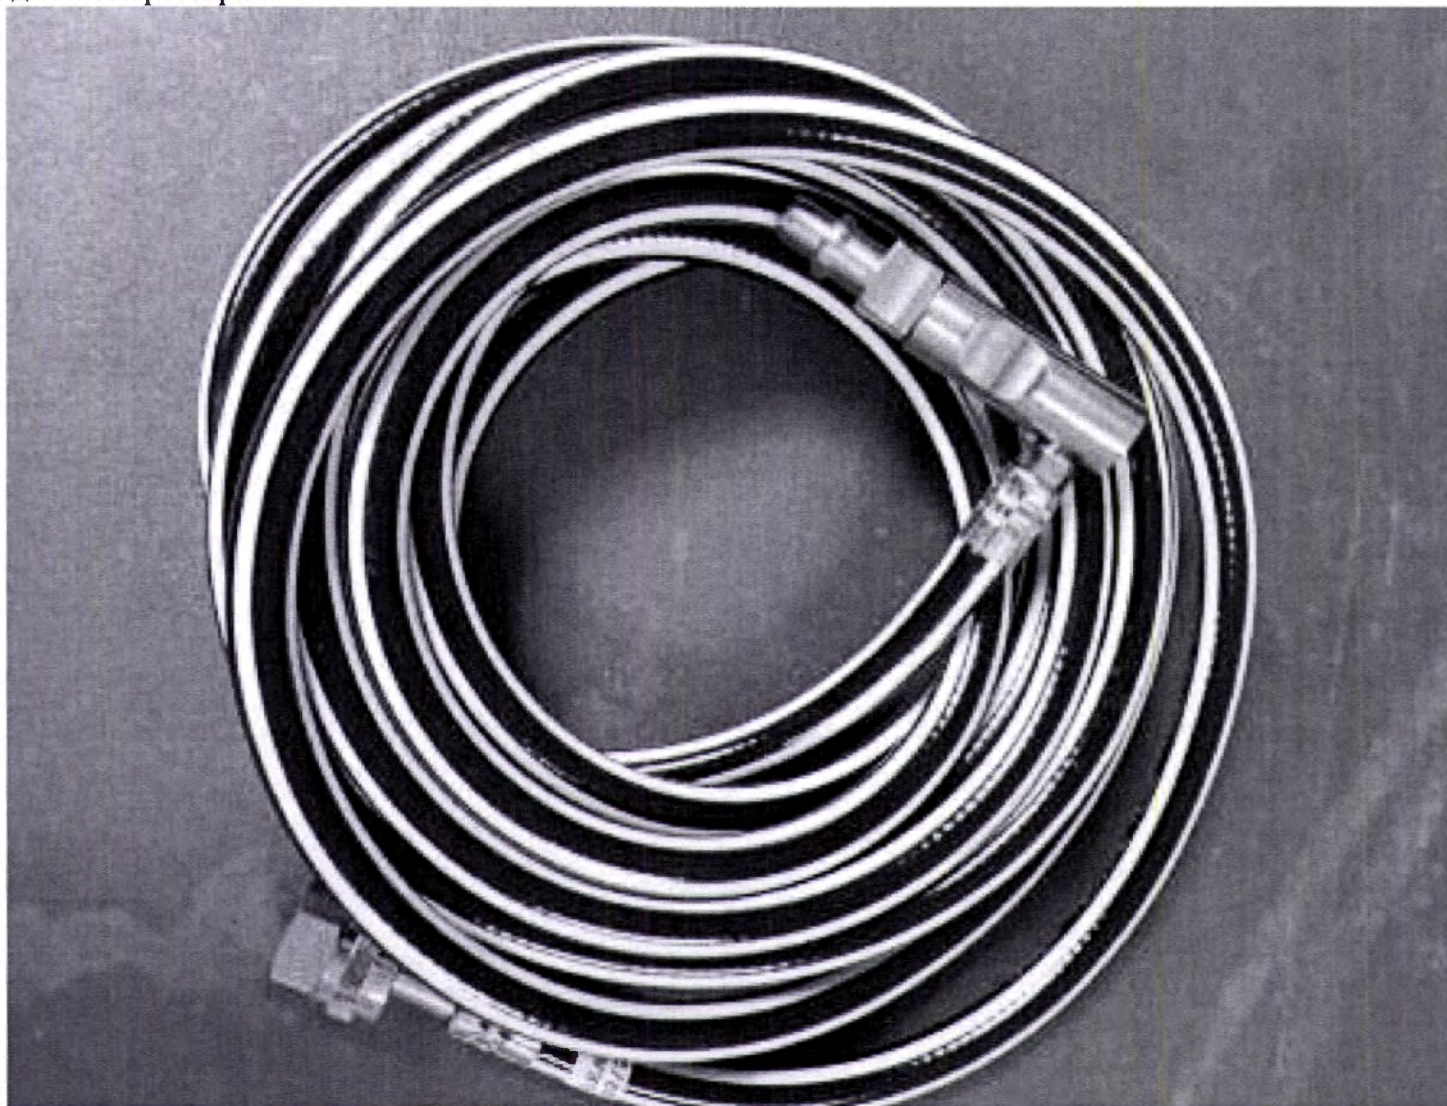


Шланг воздушный для подключения аппарата к магистрали.

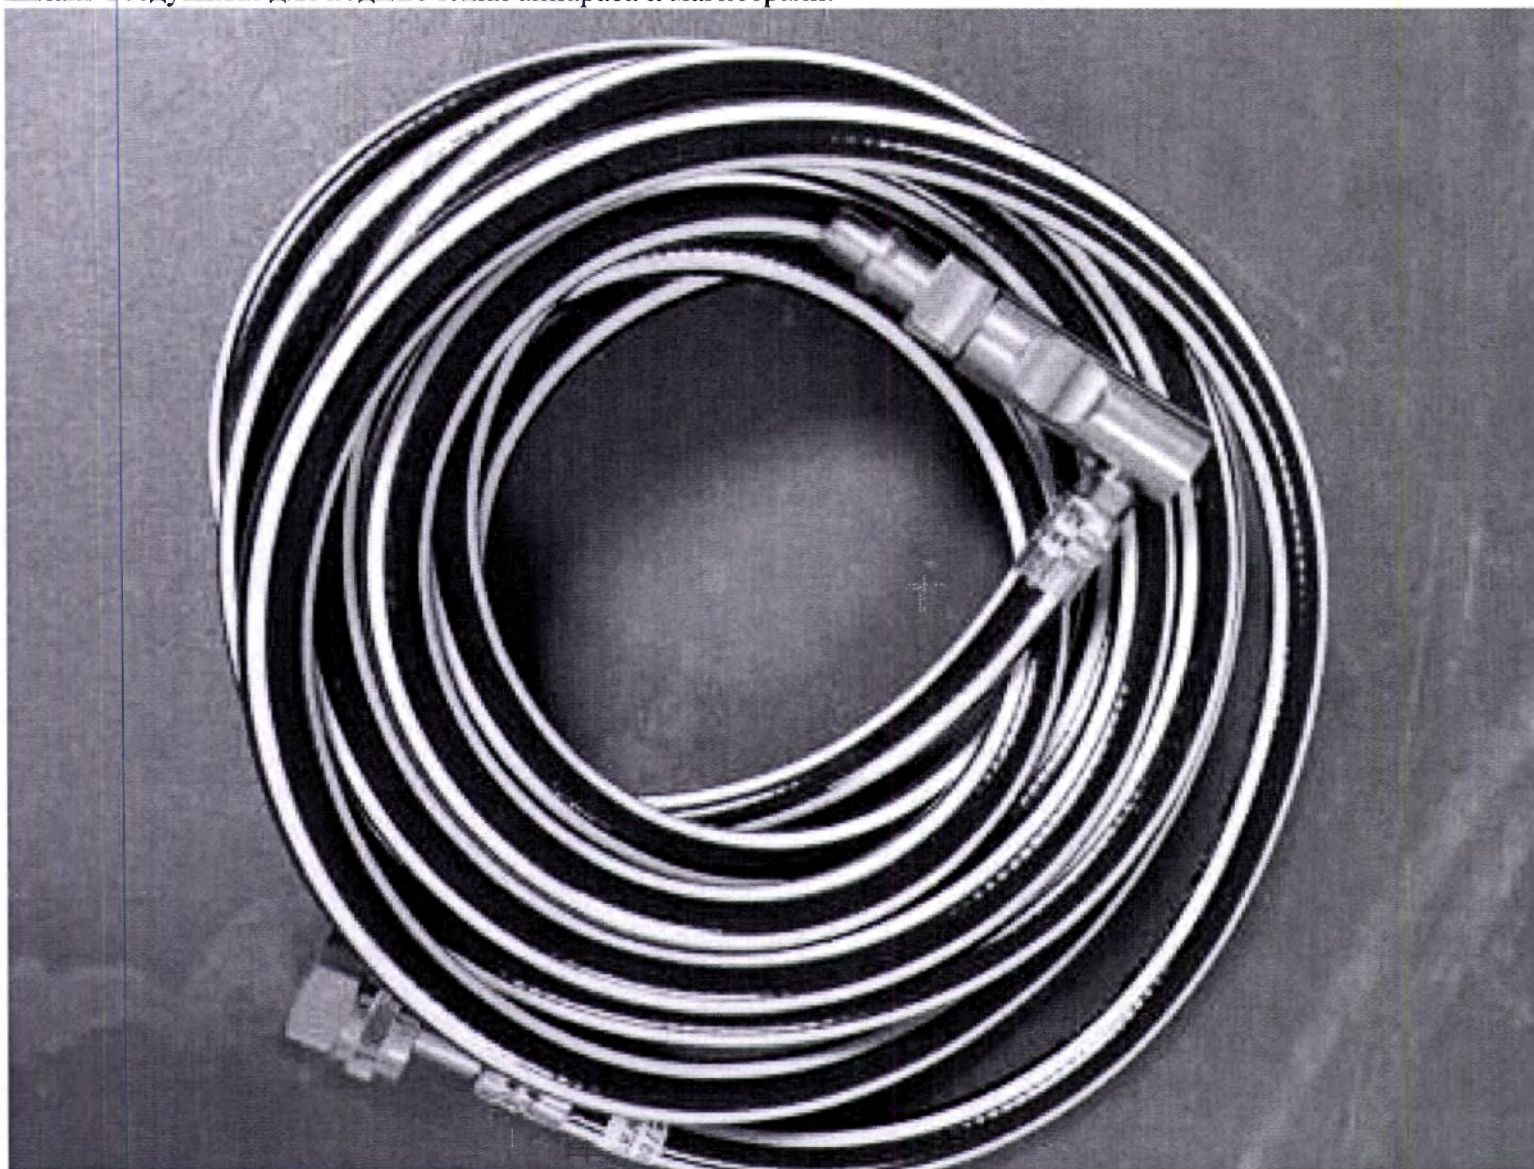


Шланг воздушный для подключения компрессора к аппарату.

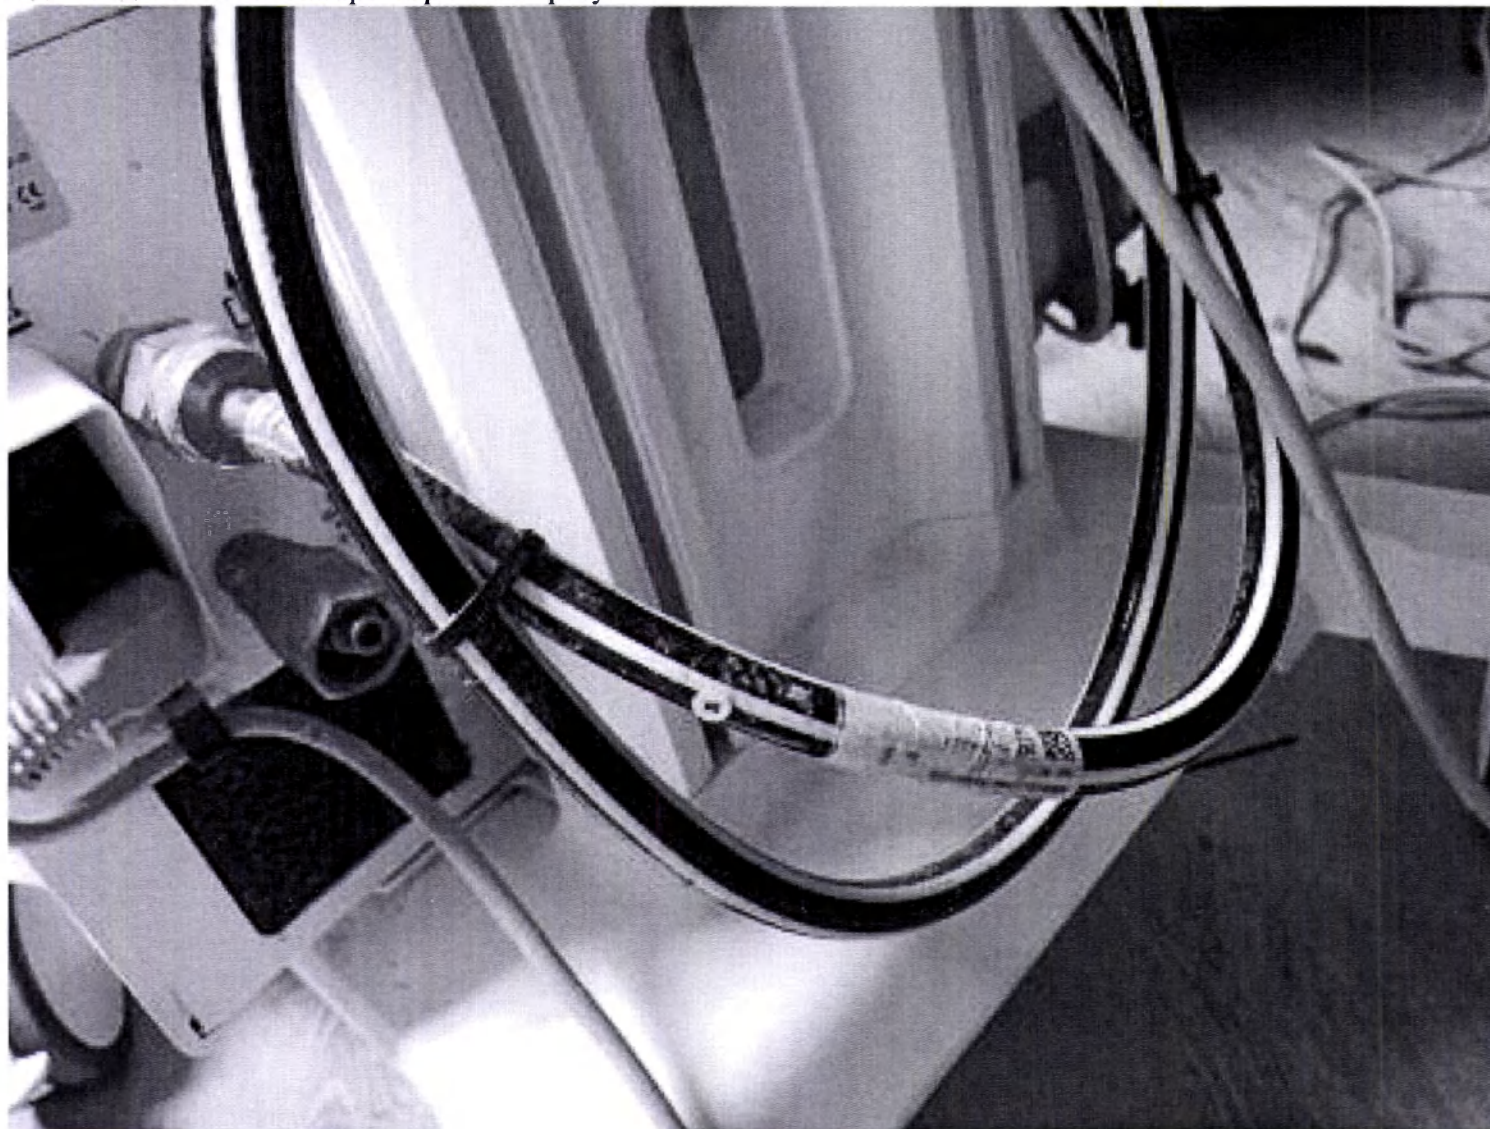


Шланг за кисели азот со штуцерами.

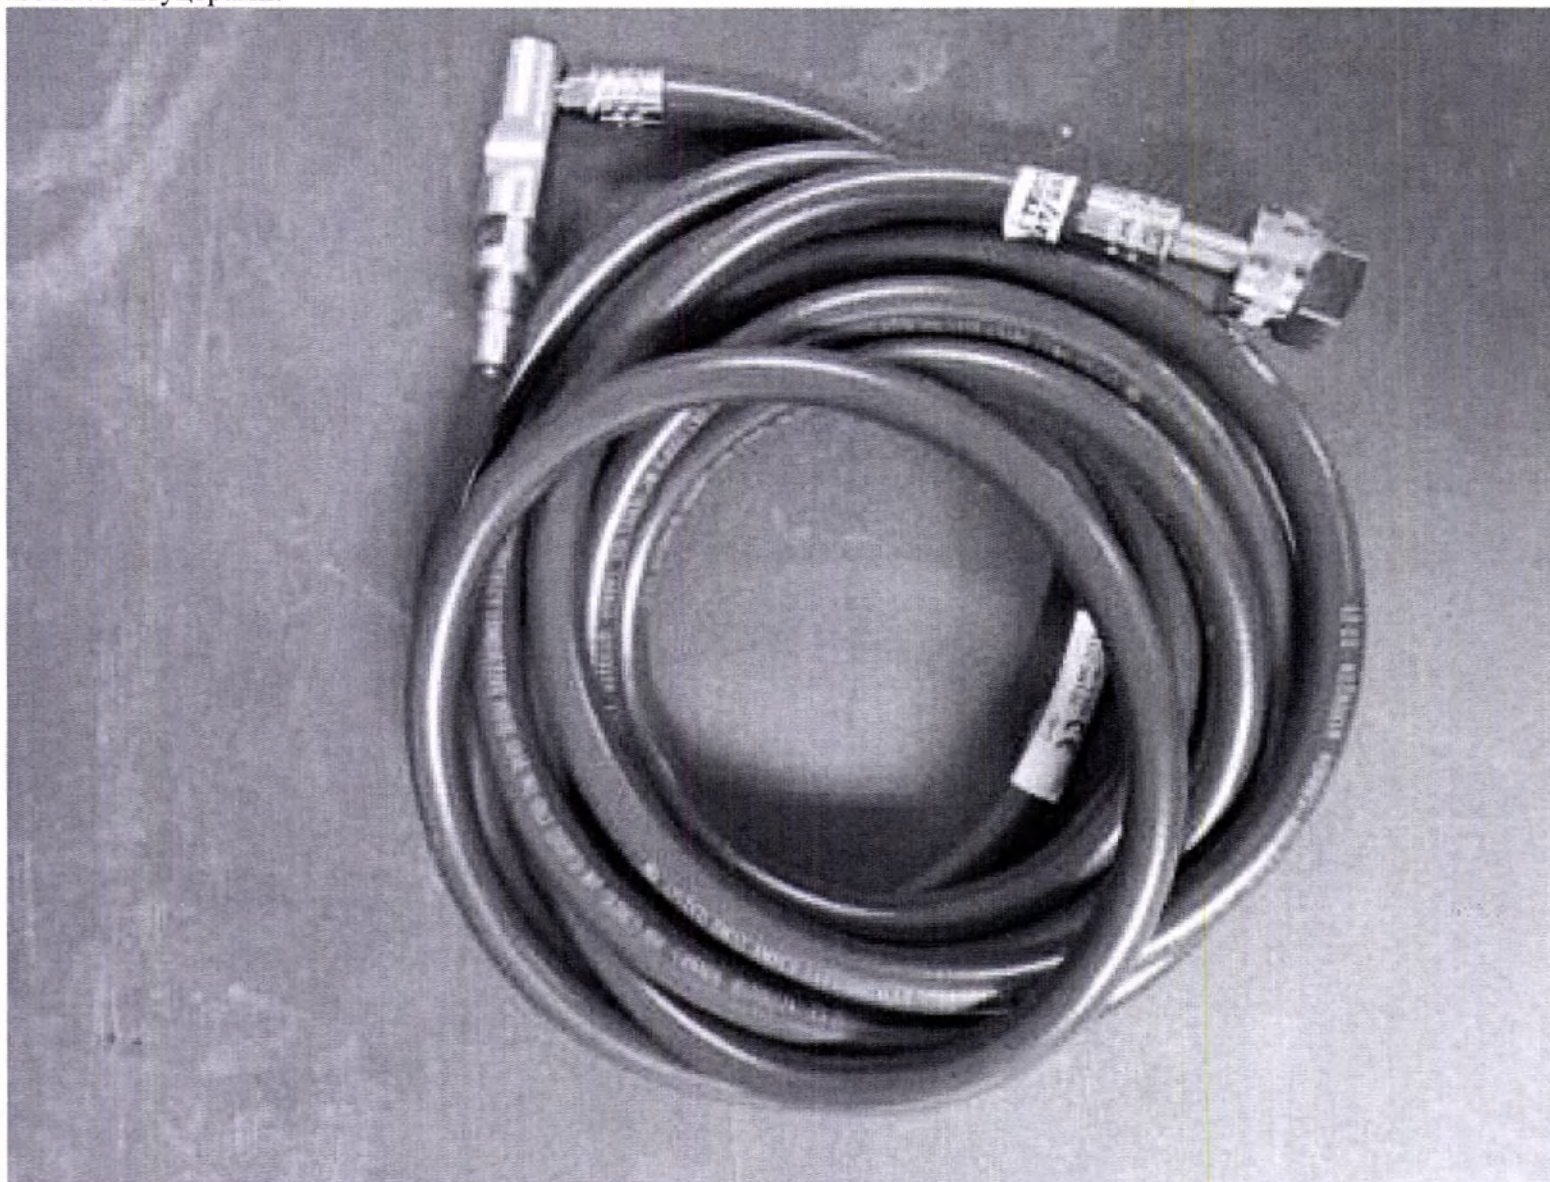


Шланг кислородный высокого давления.

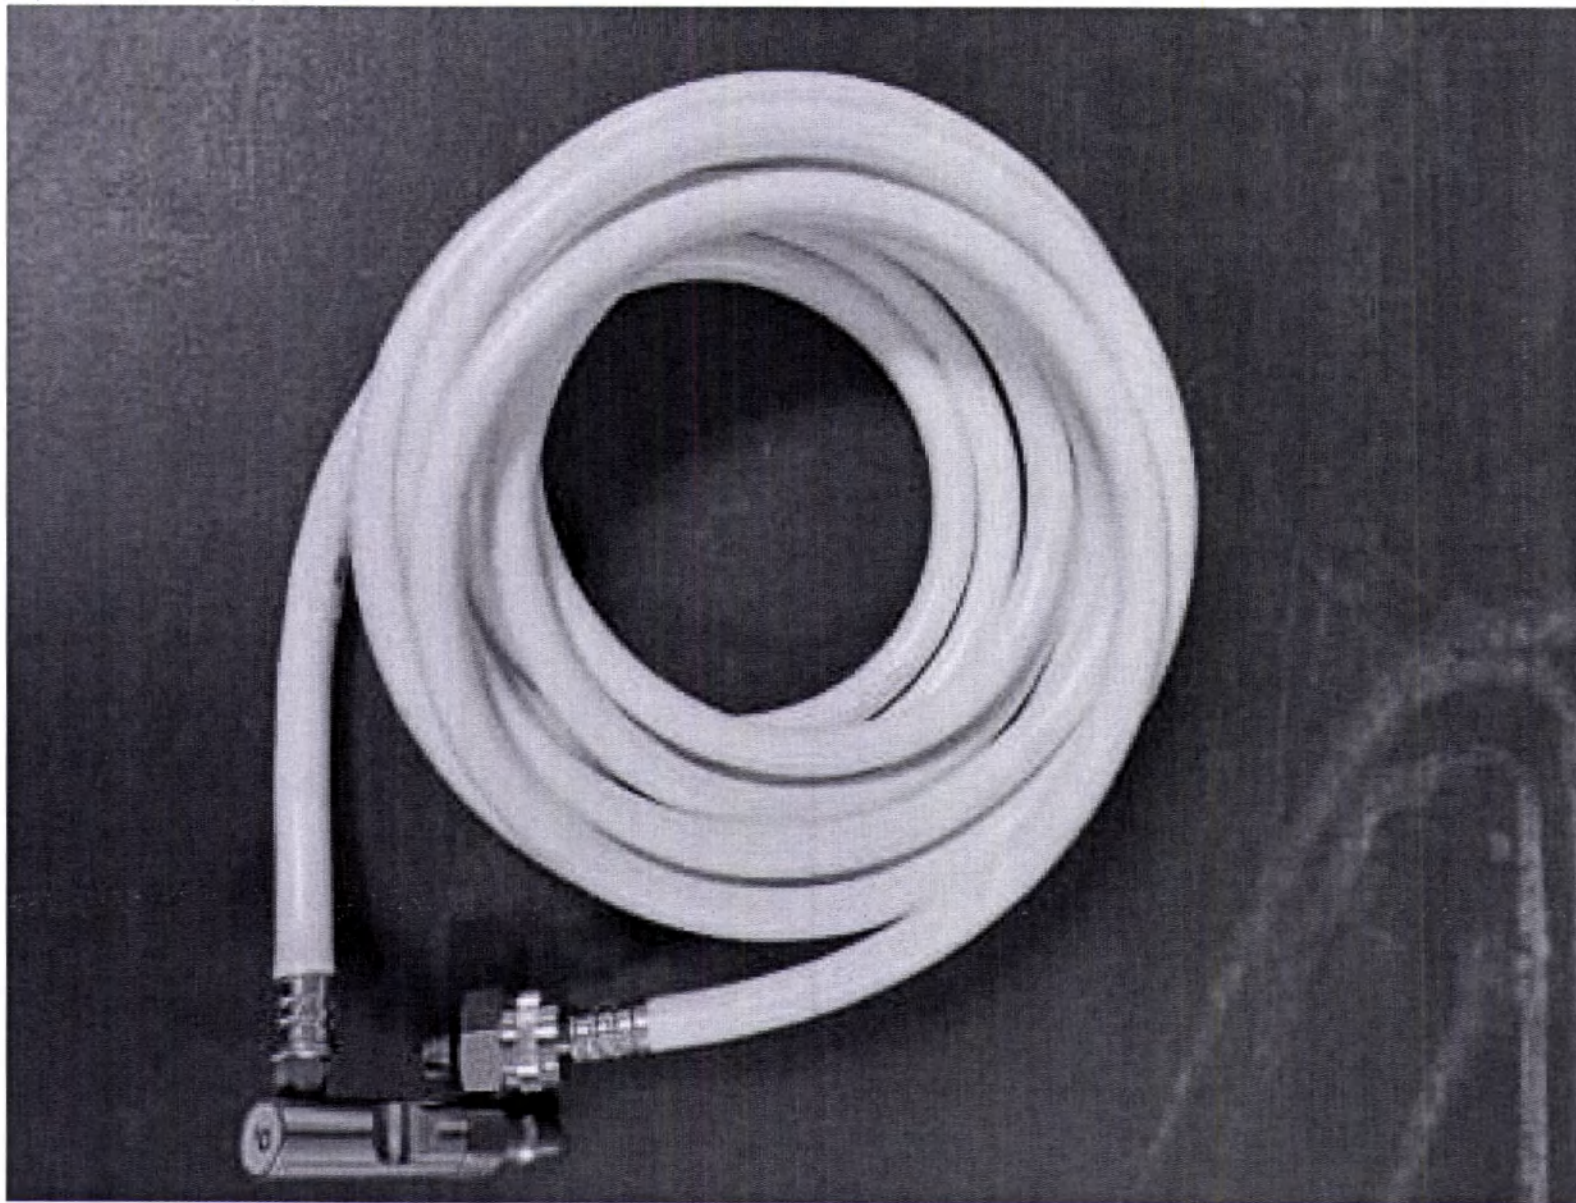


Шланг для системы эвакуации газов.

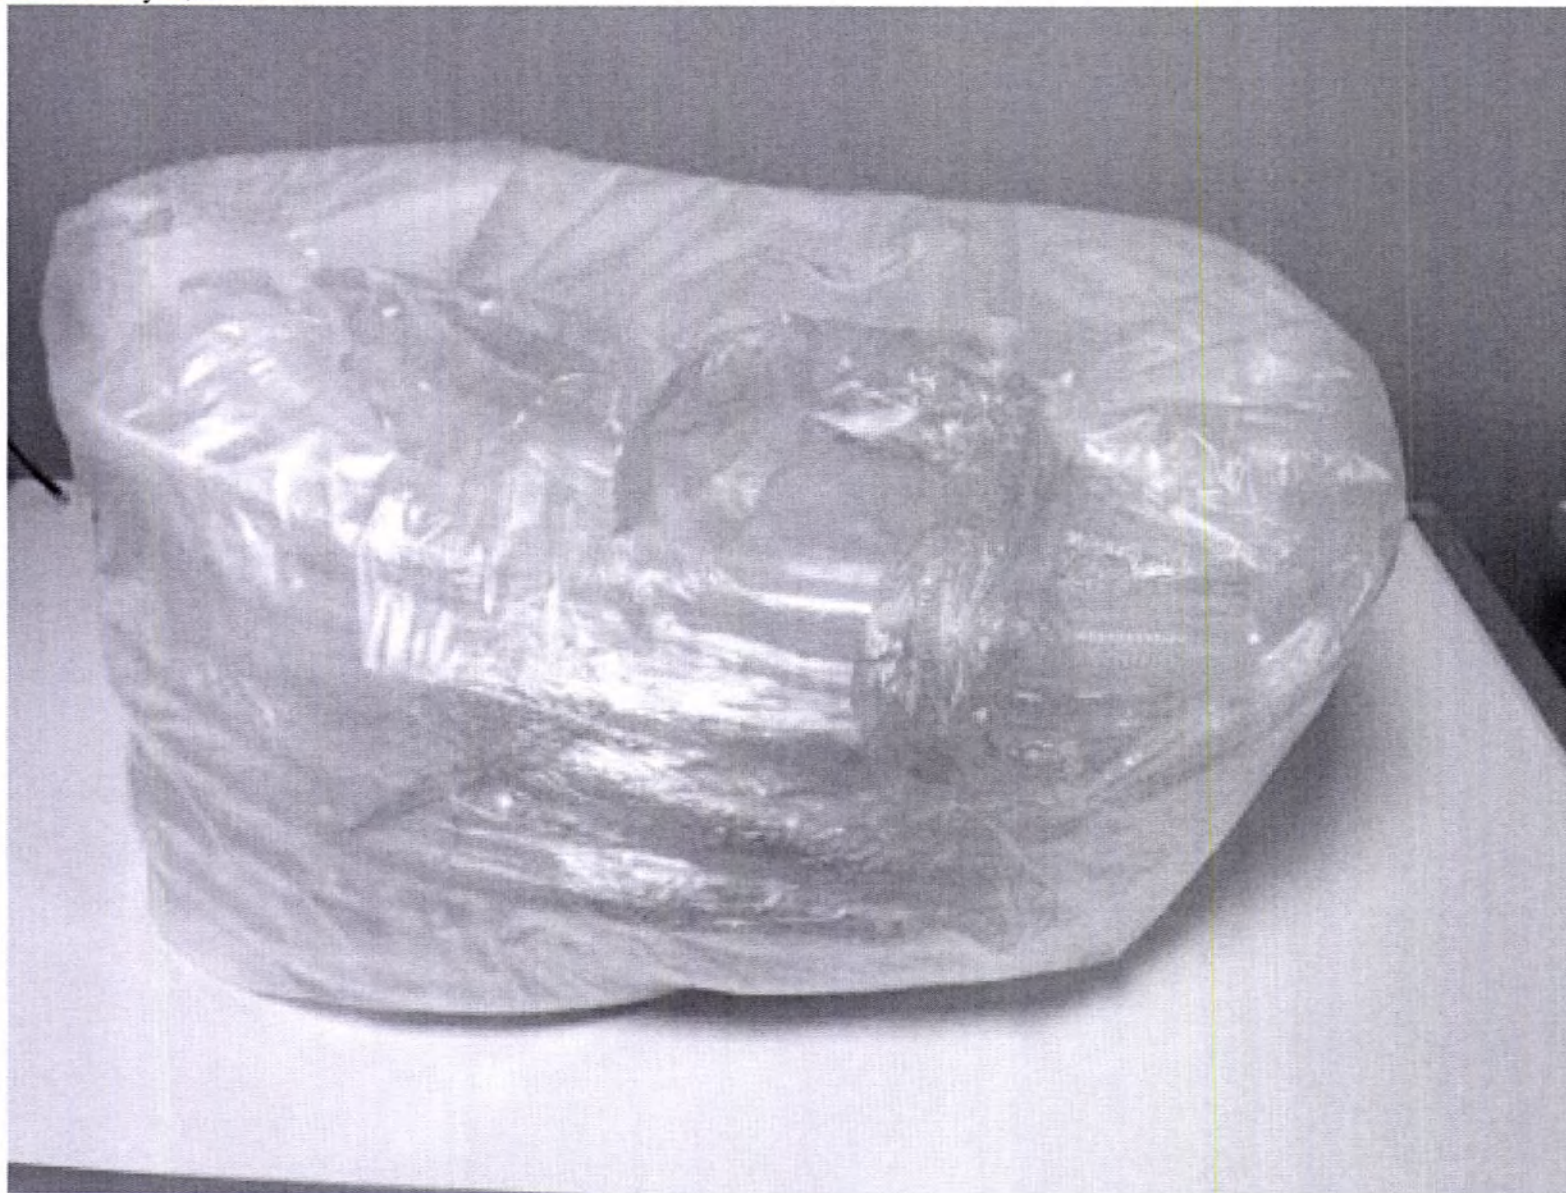

Соединительная трубка.

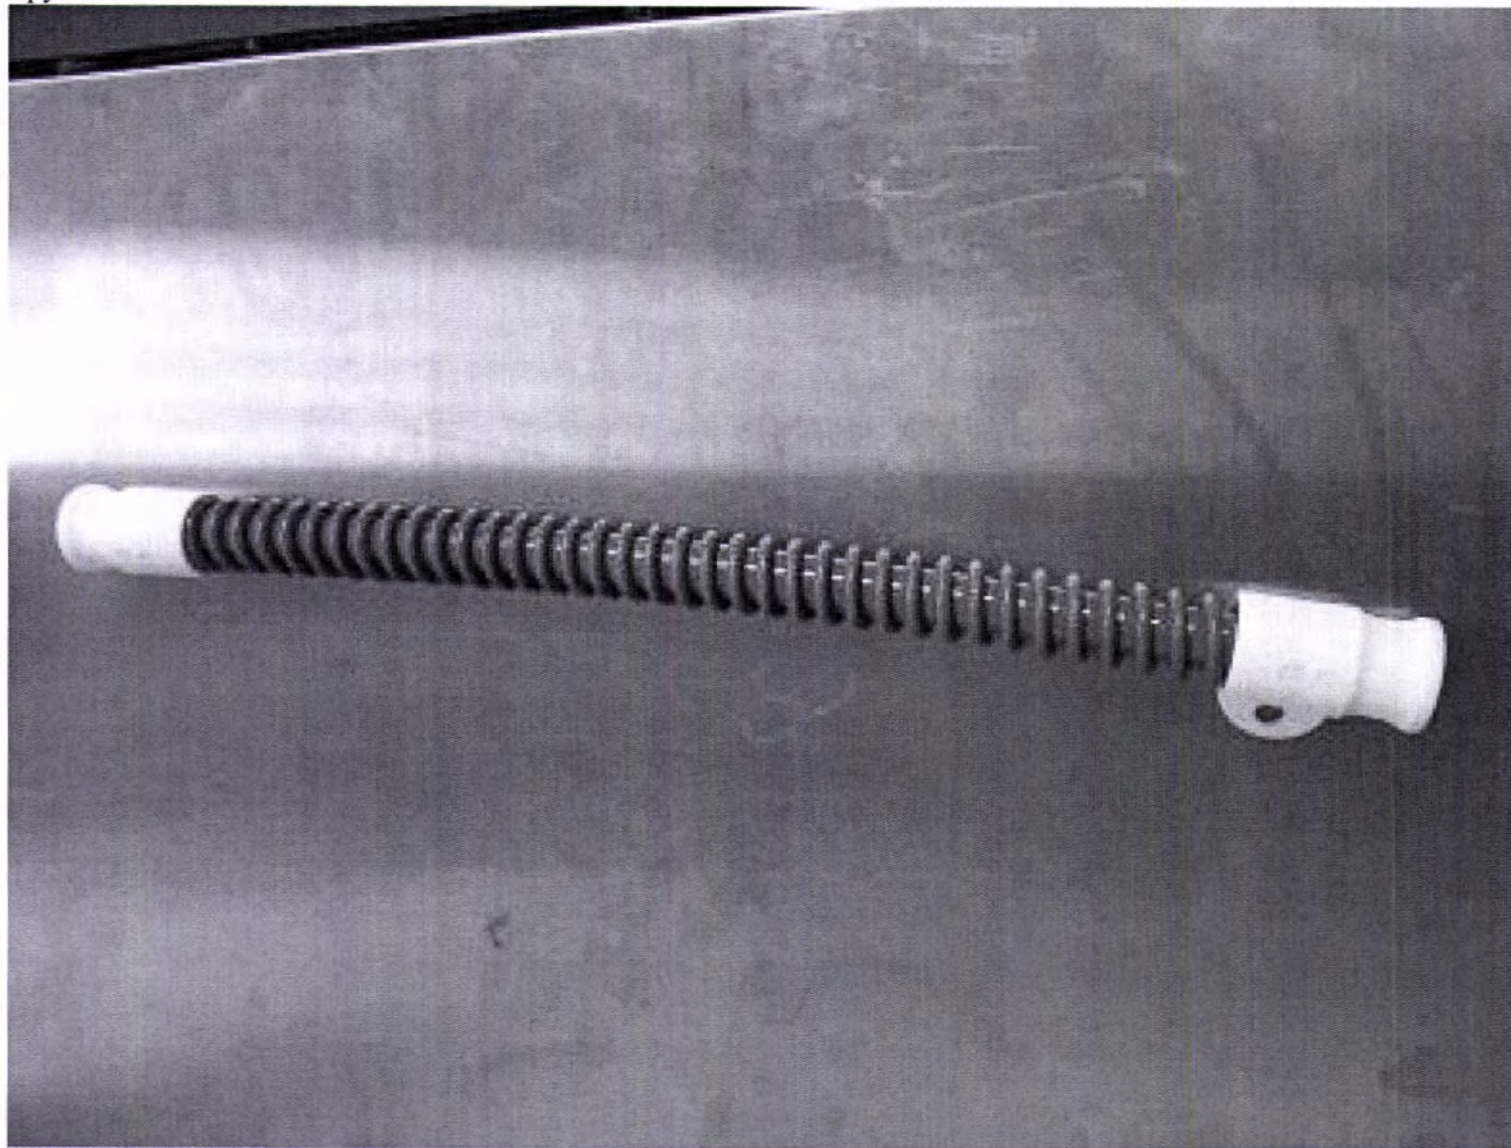


Дроссель EVAC .

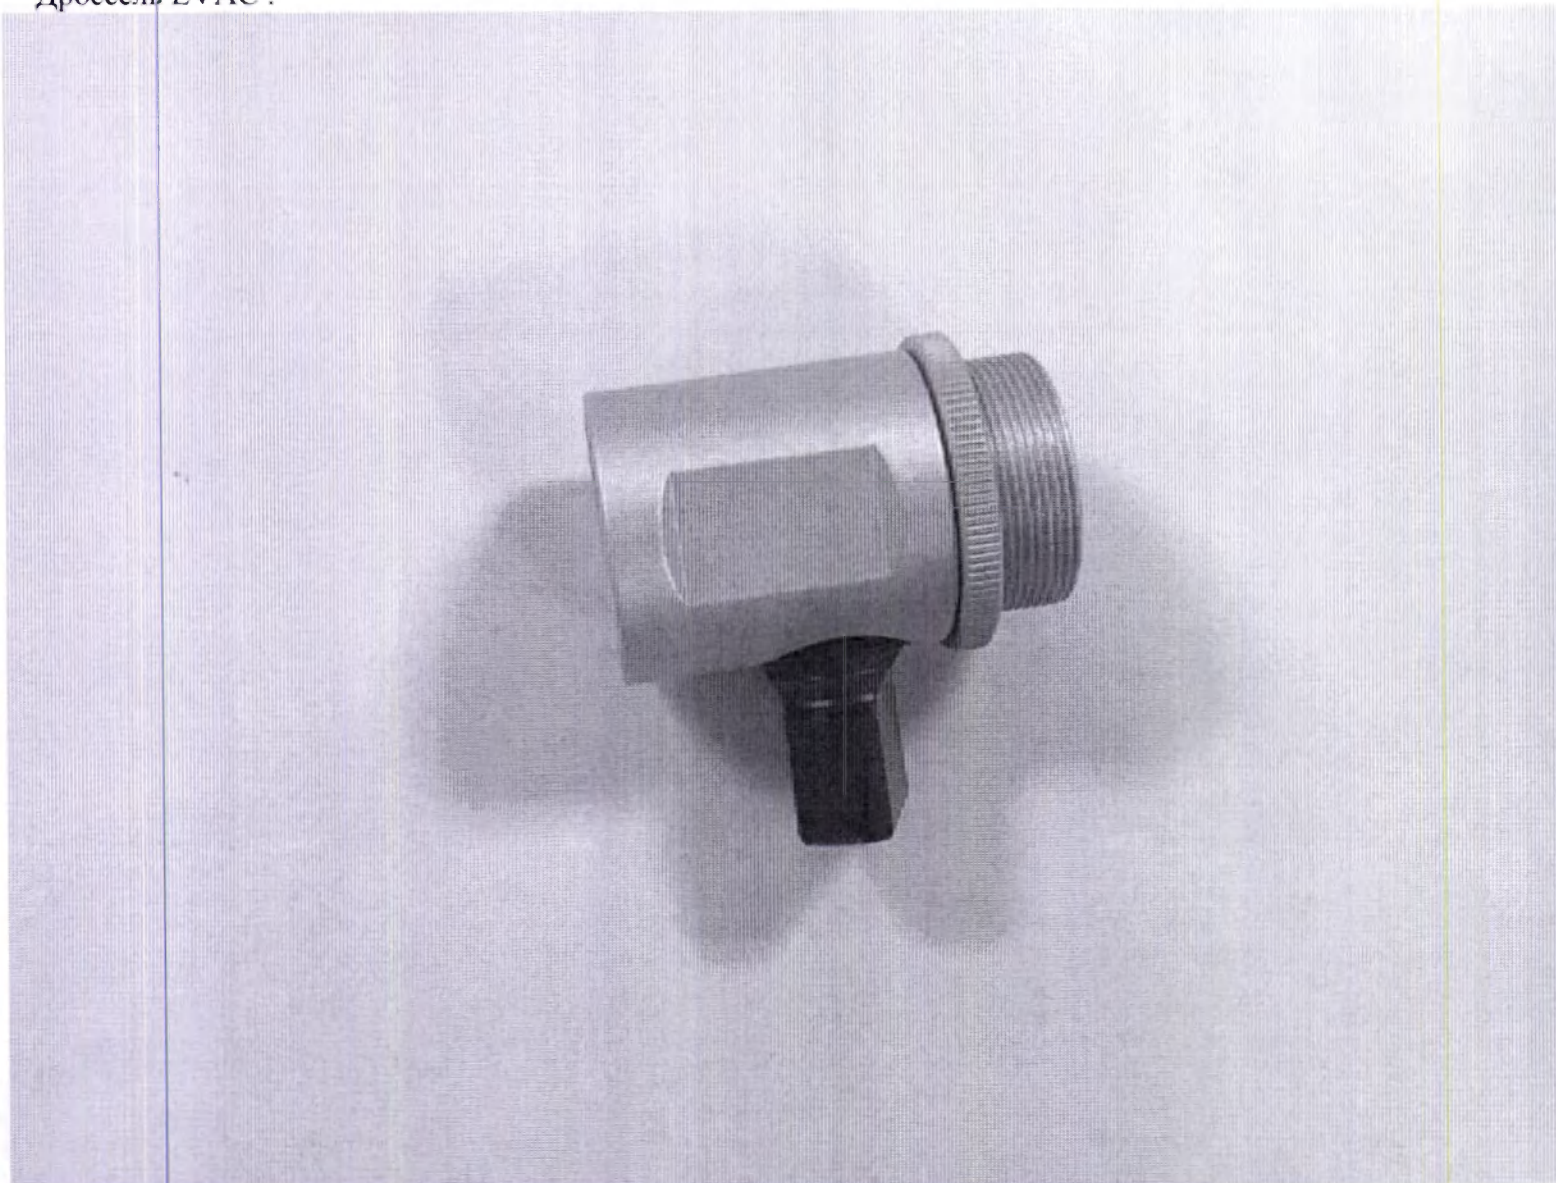


Дыхательный контур детский:

- Трубка пациента 2 шт.;
- Патрубок Y-образный пластиковый;
- Адаптер.

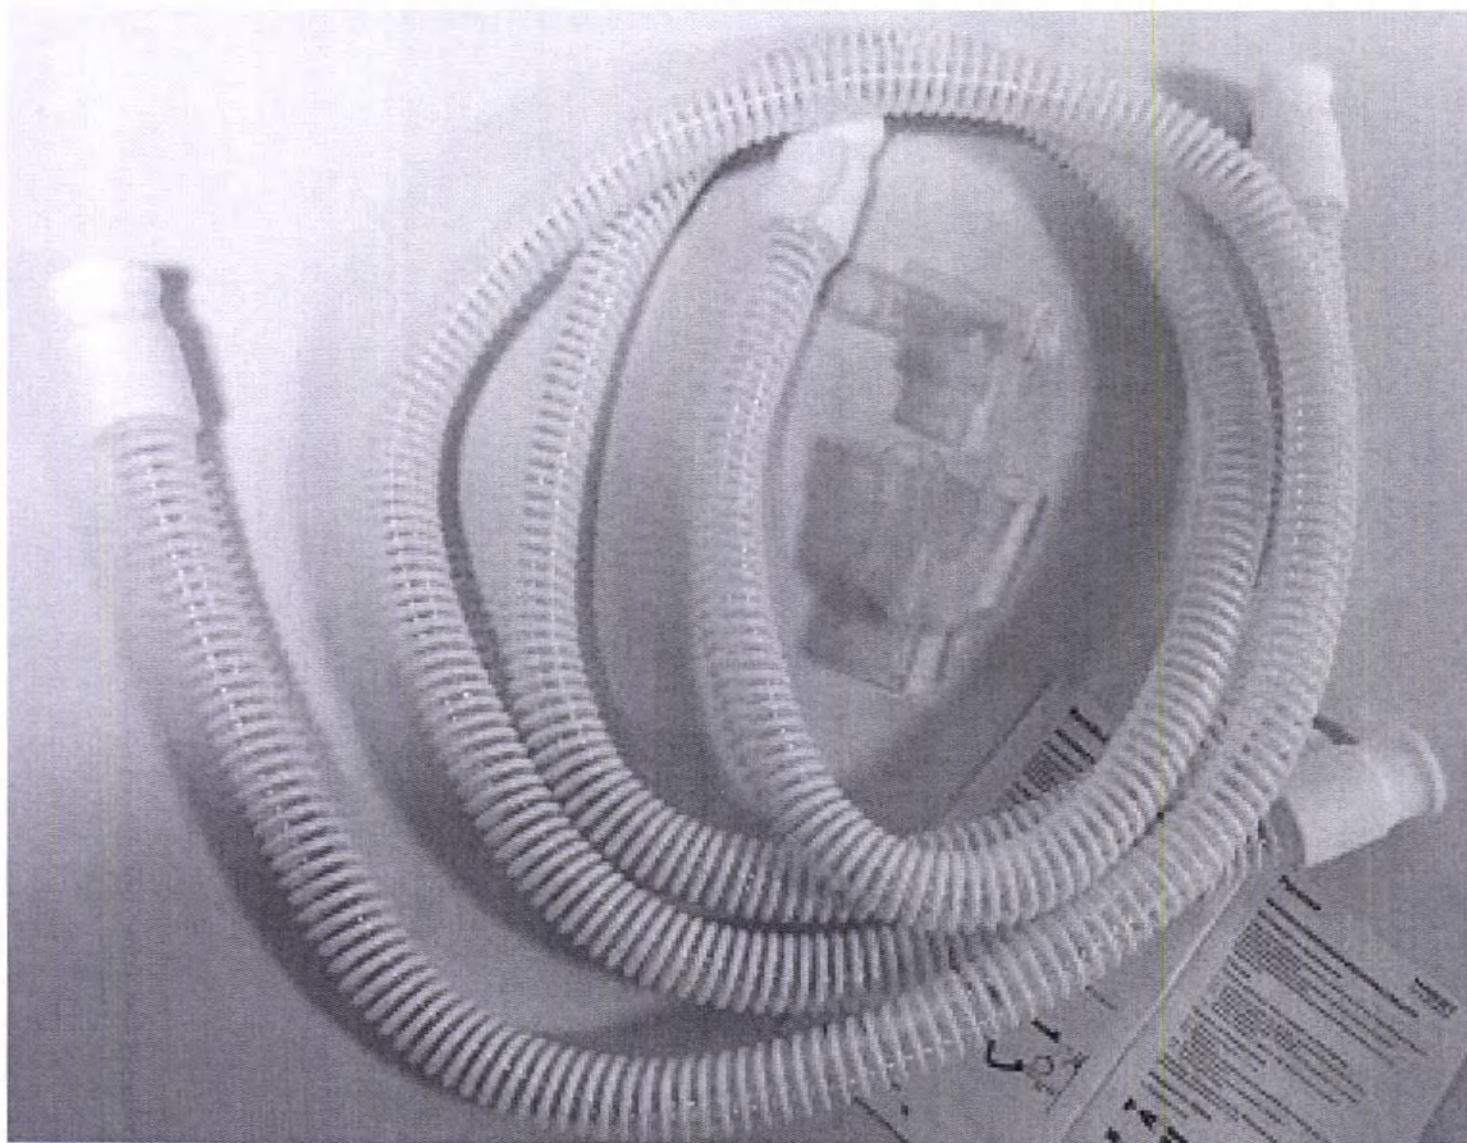


Дыхательный контур для новорожденных:

- Трубка пациента 2 шт.;
- Патрубок угловой Y-образный пластиковый.

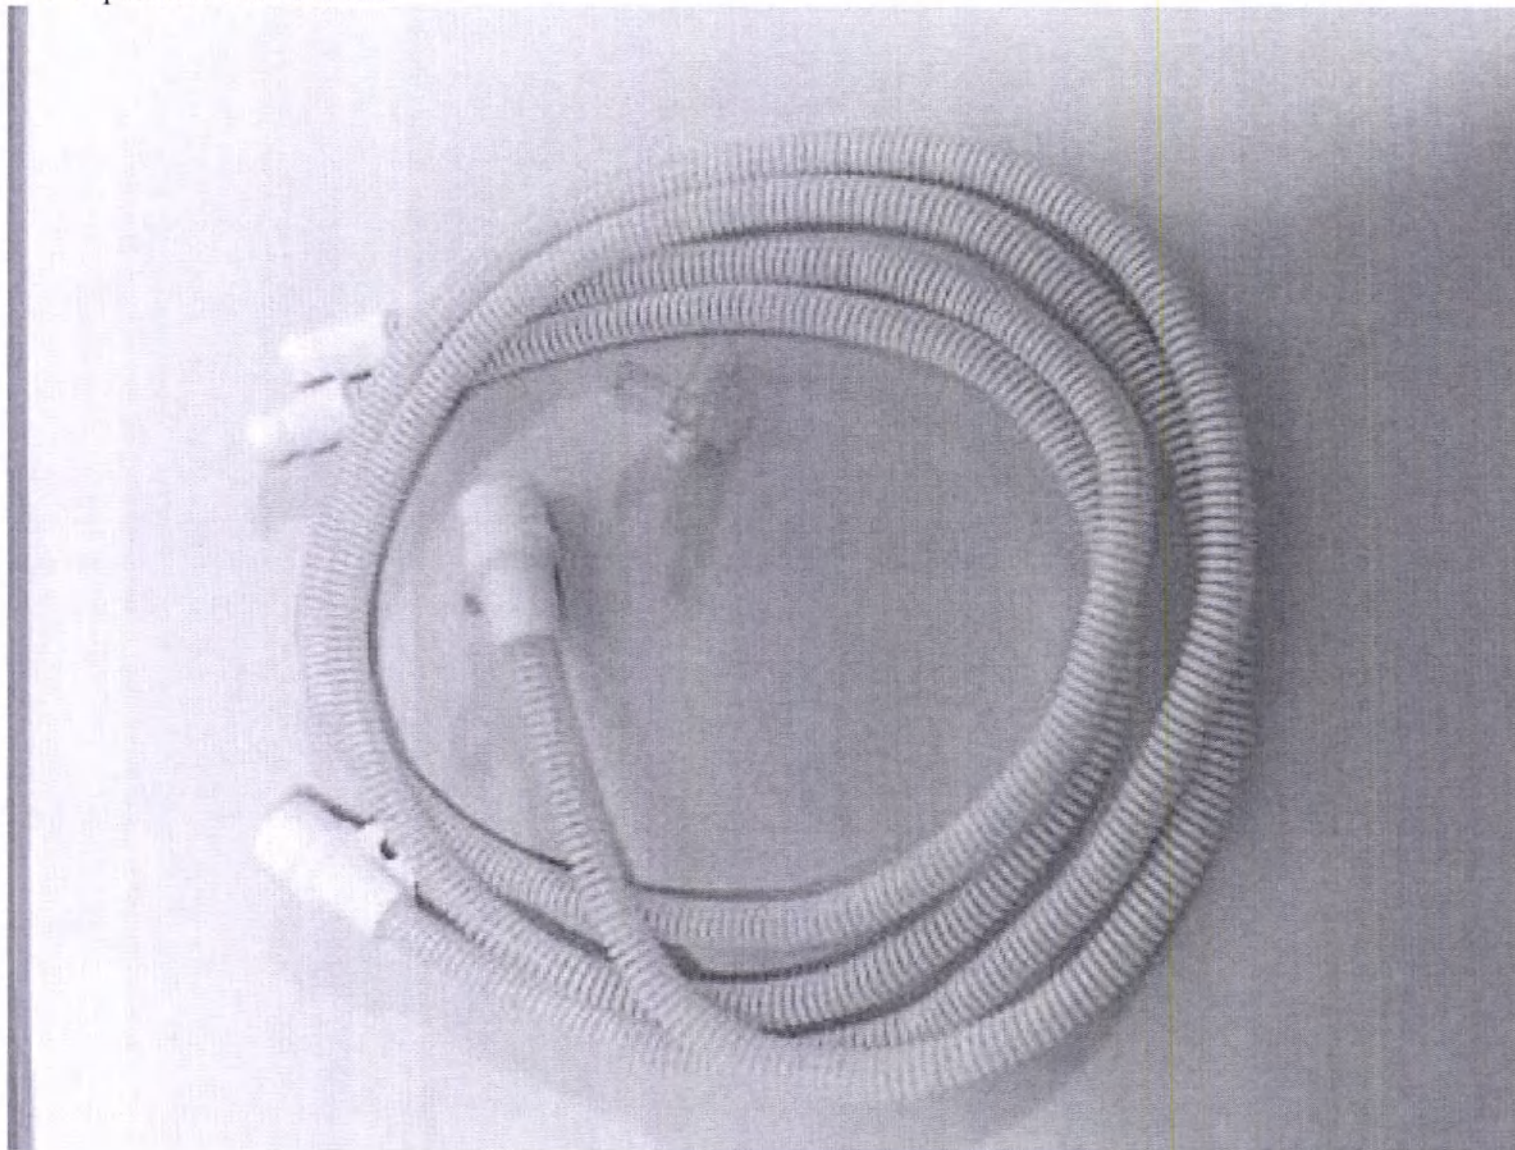

Дыхательный контур взрослый:

- Трубка пациента 2 шт.;
- Патрубок Y-образный пластиковый;
- Адаптер.

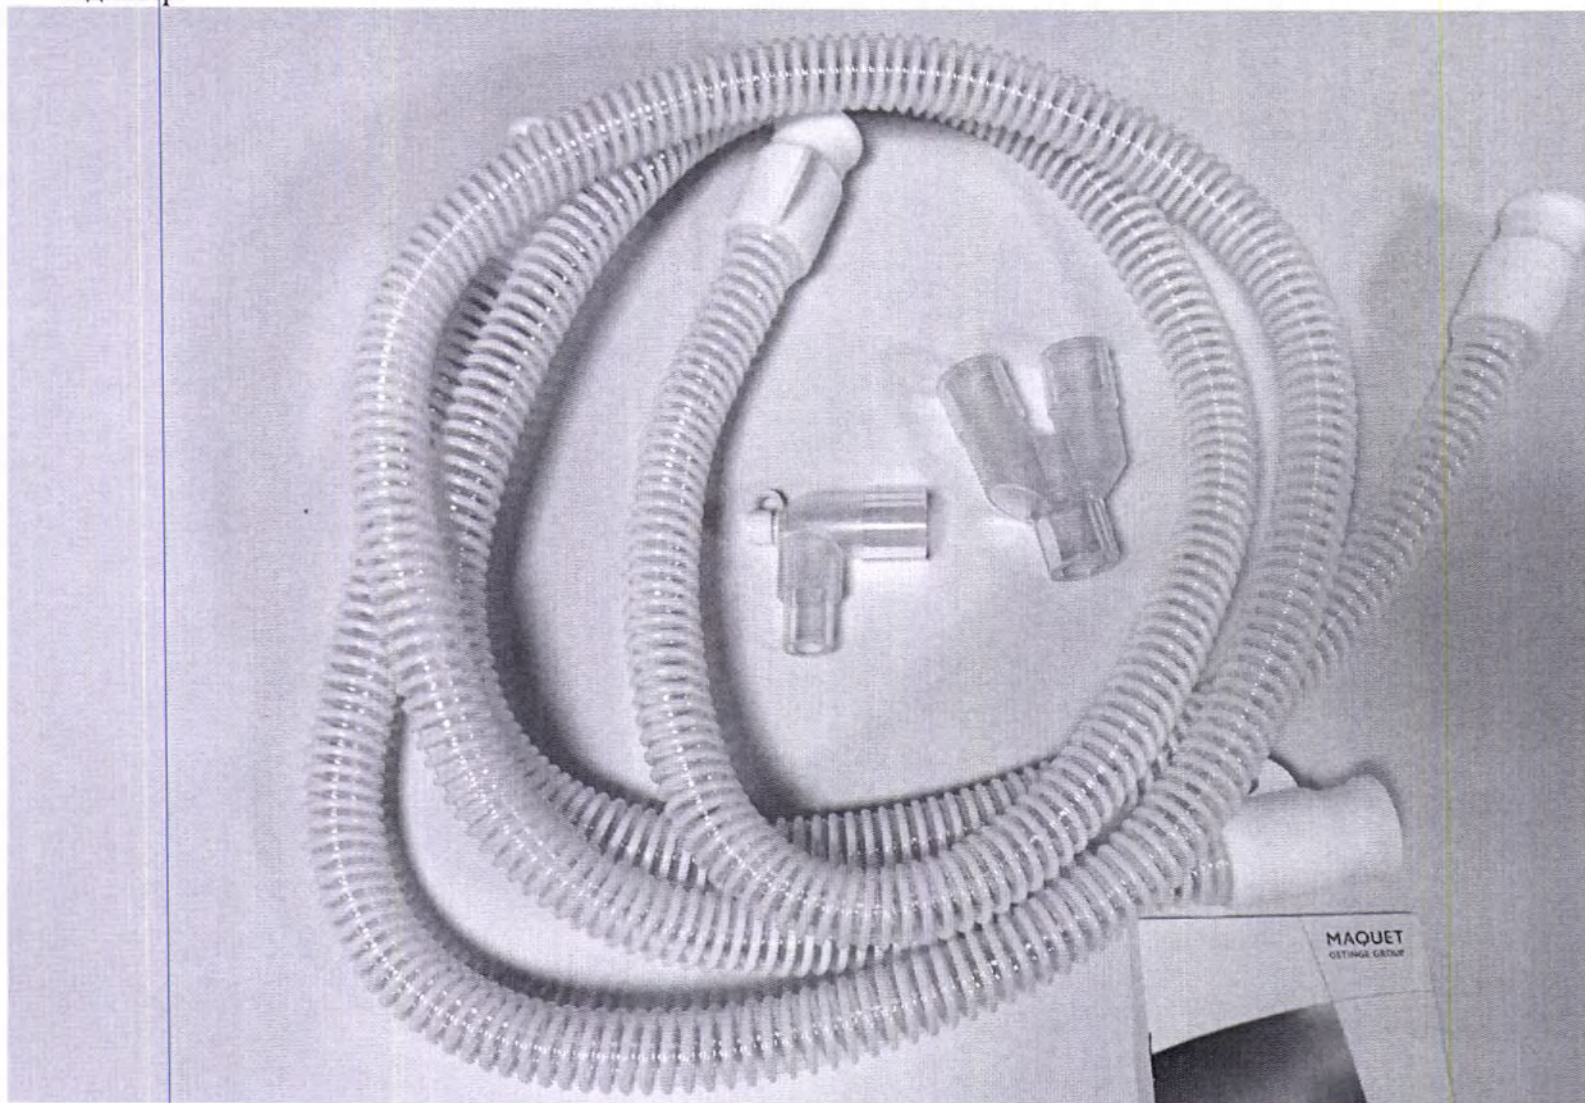

Дыхательный контур для взрослых одноразовый:

- Трубка пациента для взрослых 3шт;
- Мешок дыхательный;
- Y-образный патрубок;
- Адаптер;
- Трубка газовая пробоотборная.



Дыхательный контур для новорожденных одноразовый:

- Трубка пациента для новорожденных, 3 шт.;
- Мешок дыхательный;
- Y-образный патрубок;
- Адаптер;
- Трубка газовая пробоотборная.




Дыхательный контур для детей одноразовый:

- Трубка пациента для детей, 3 шт.;
- Мешок дыхательный;
- Y-образный патрубков;
- Адаптер;
- Трубка газовая пробоотборная.




Дыхательный контур для новорожденных многоразовый:

- Трубка пациента для новорожденных;
- Мешок дыхательный;
- Адаптер.

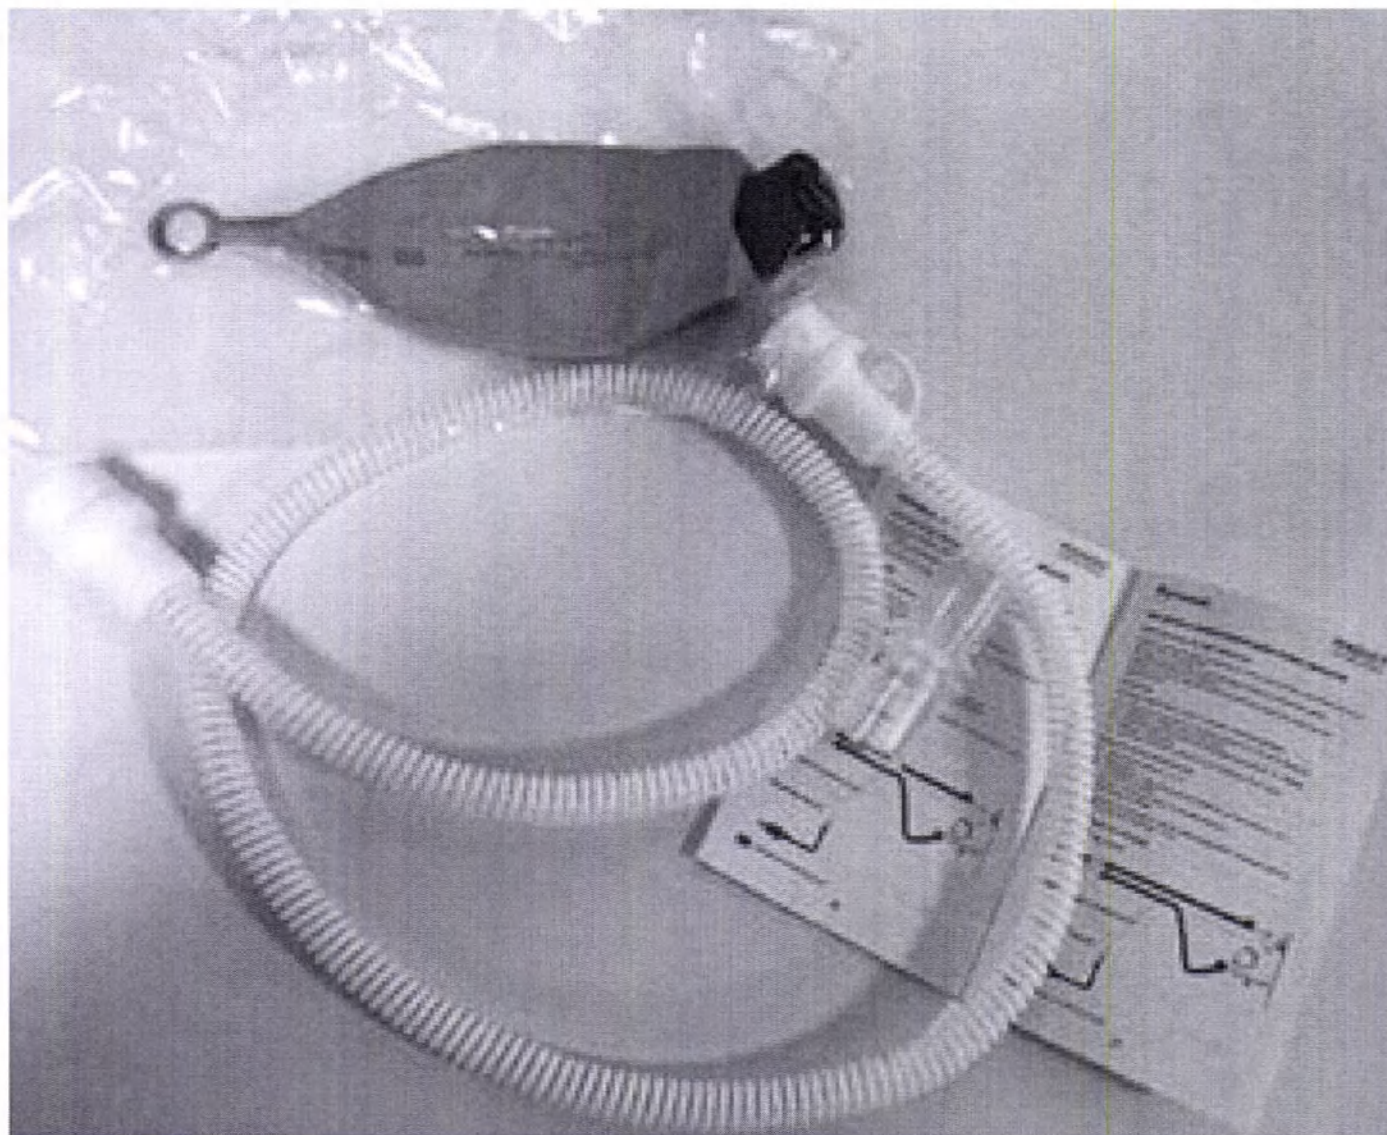


Дыхательный контур для взрослых многоразовый:

- Трубка пациента для взрослых;
- Мешок дыхательный;
- Адаптер.

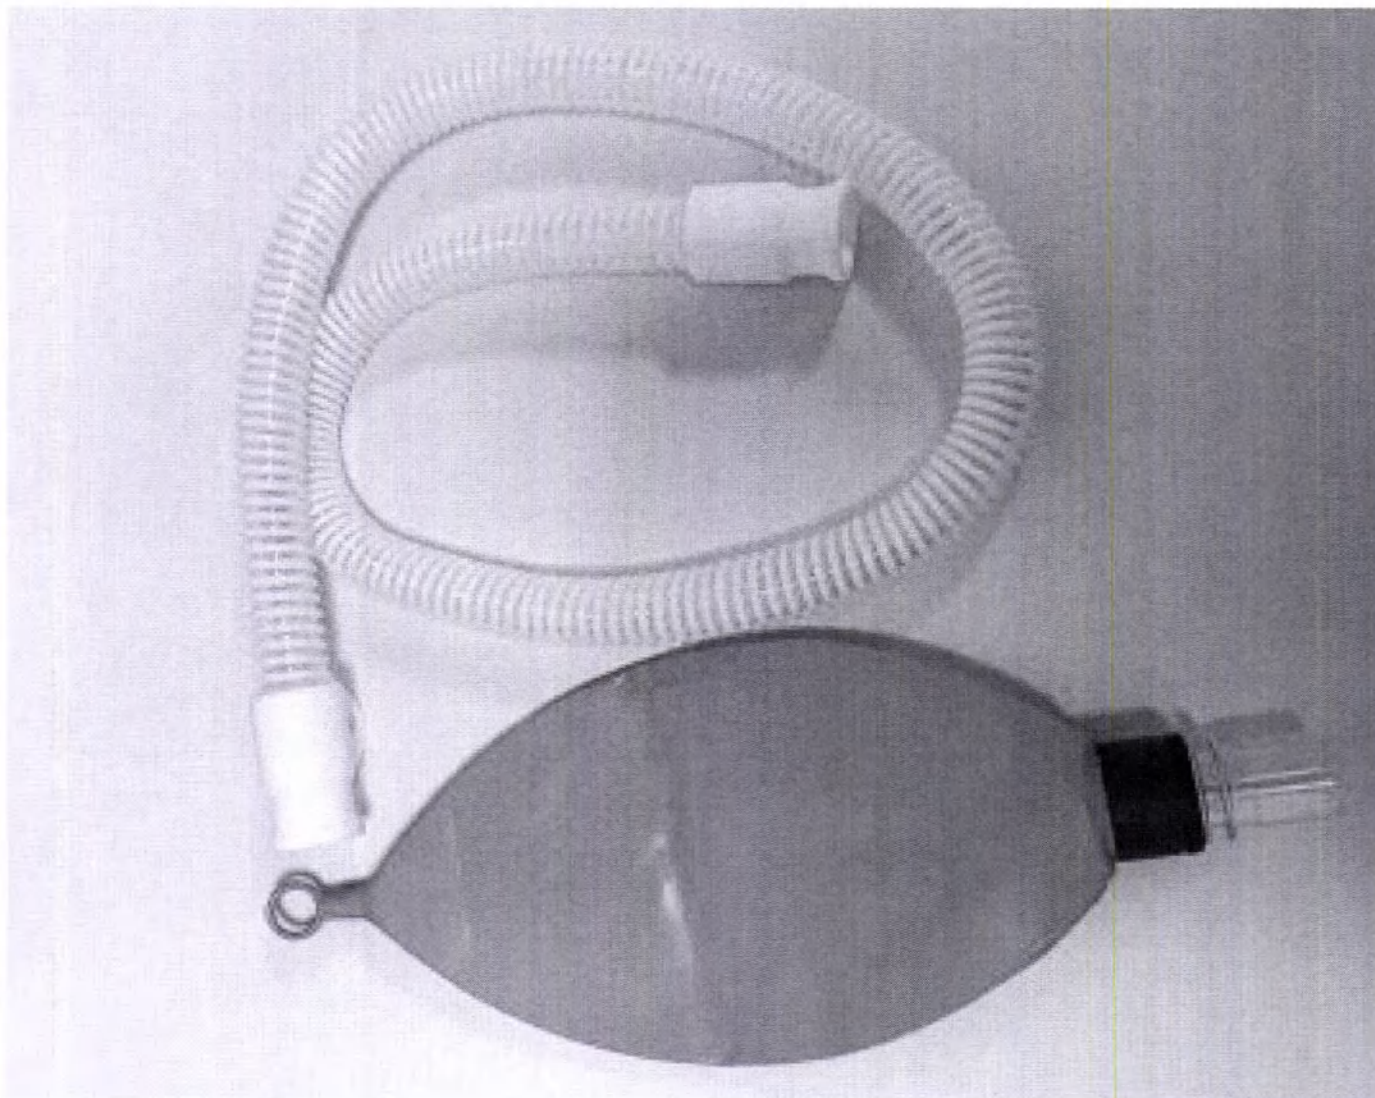


Дыхательный контур для детей многоразовый:

- Трубка пациента для детей;
- Мешок дыхательный;
- Адаптер.

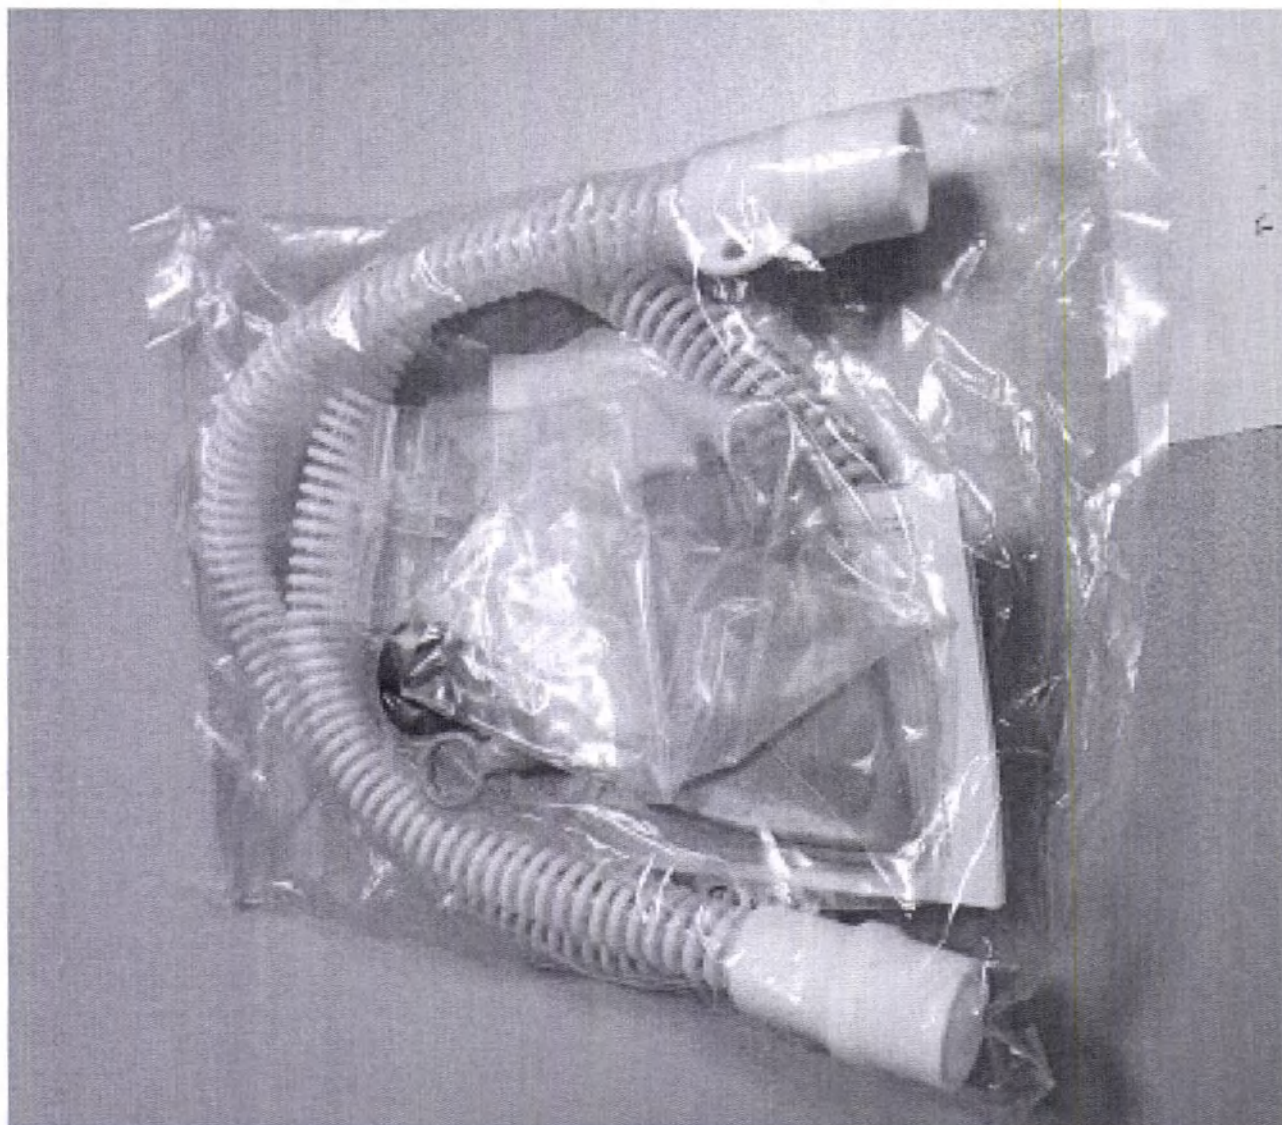


Компрессор Mini (при необходимости):


- Сливной флакон;
- Кабель сетевой электрический;

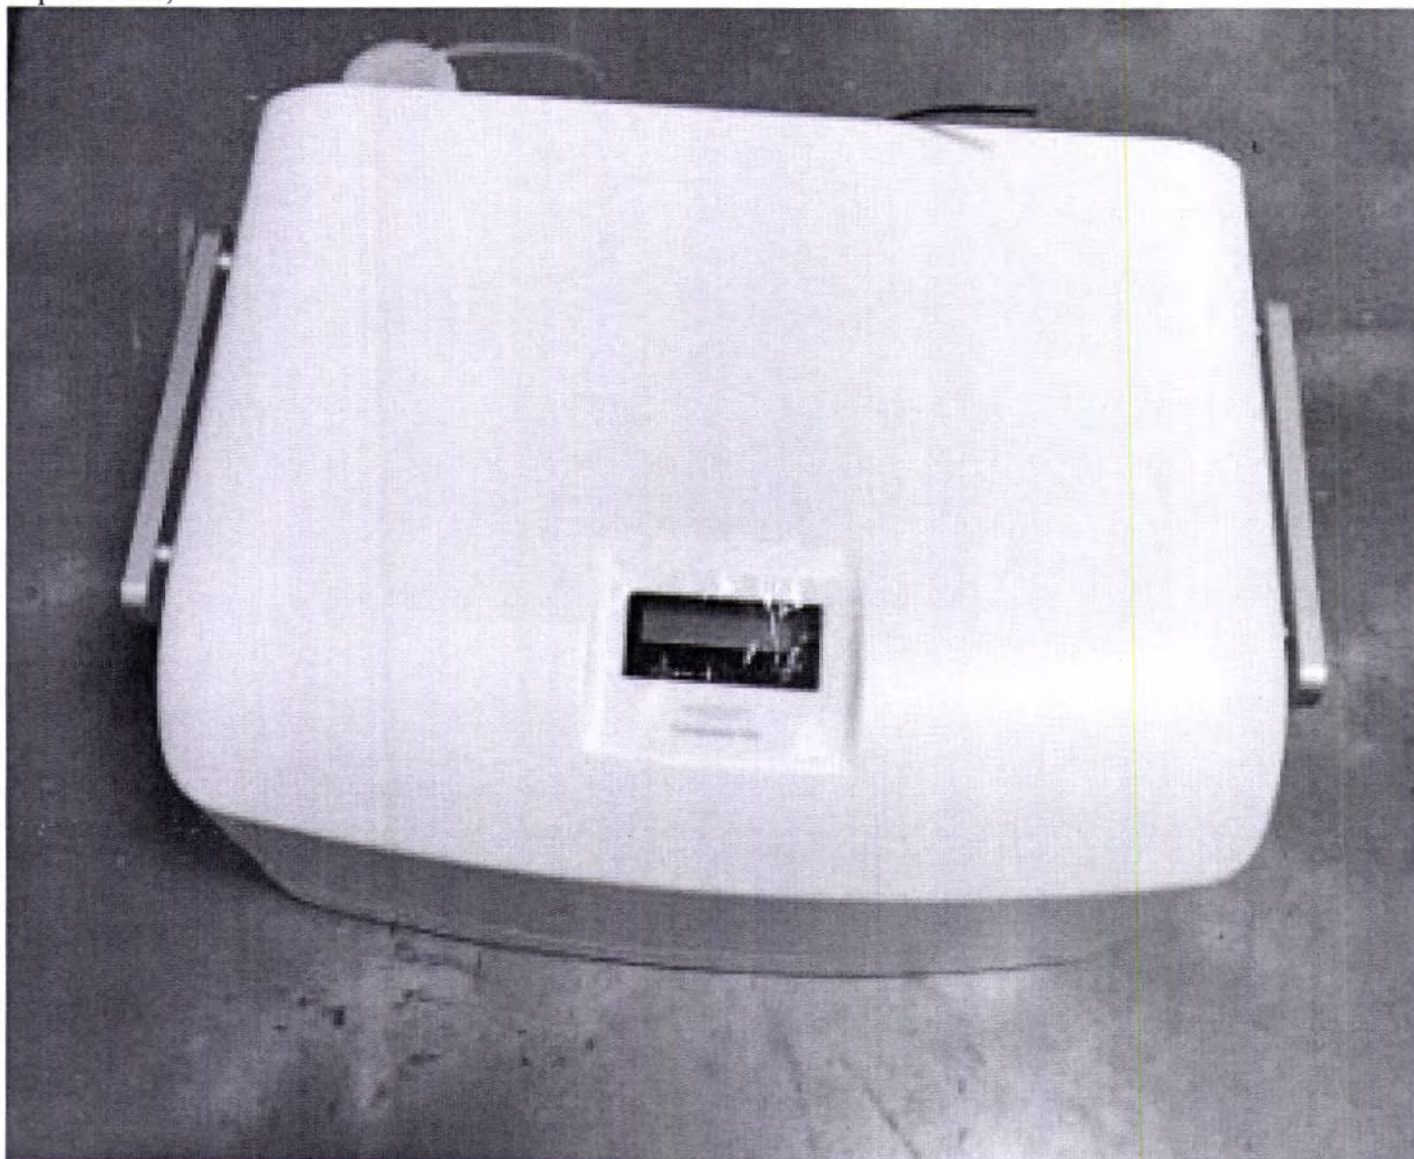


Маски анестезиологические многоразовые, размеры 0, 1, 2, 3, 4, 5.

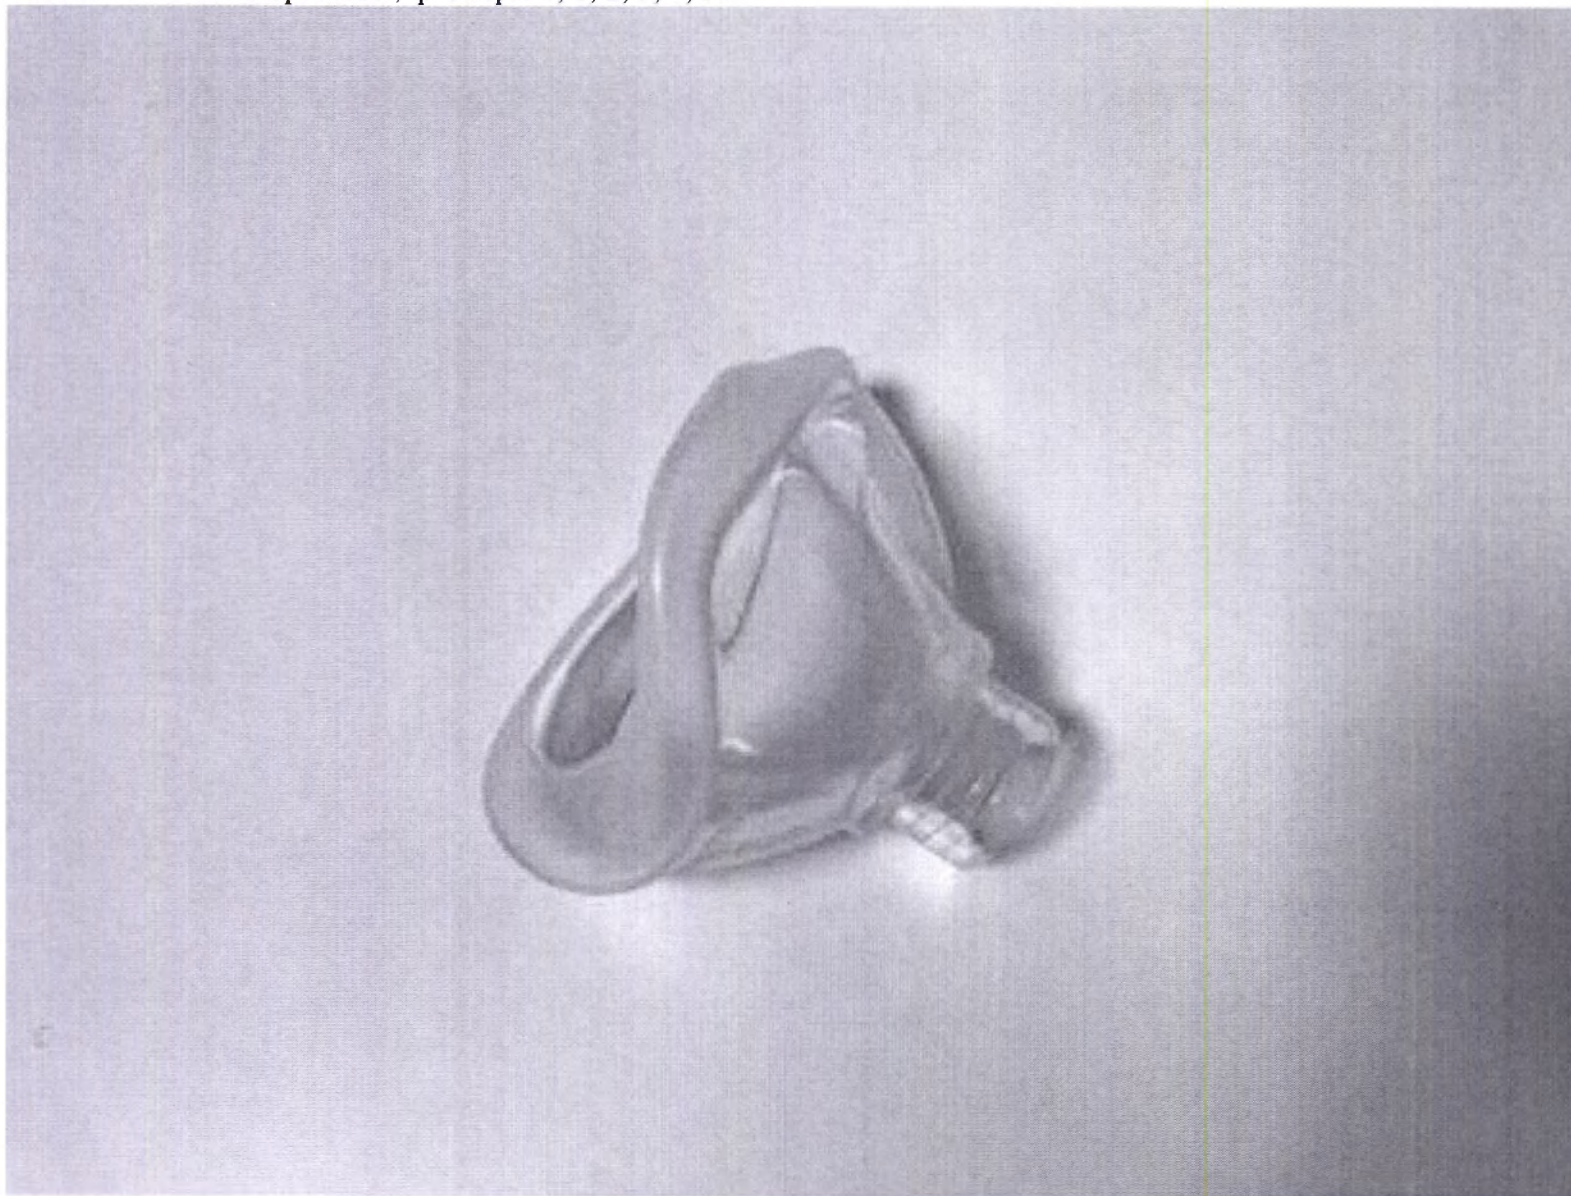


Кабель питания.

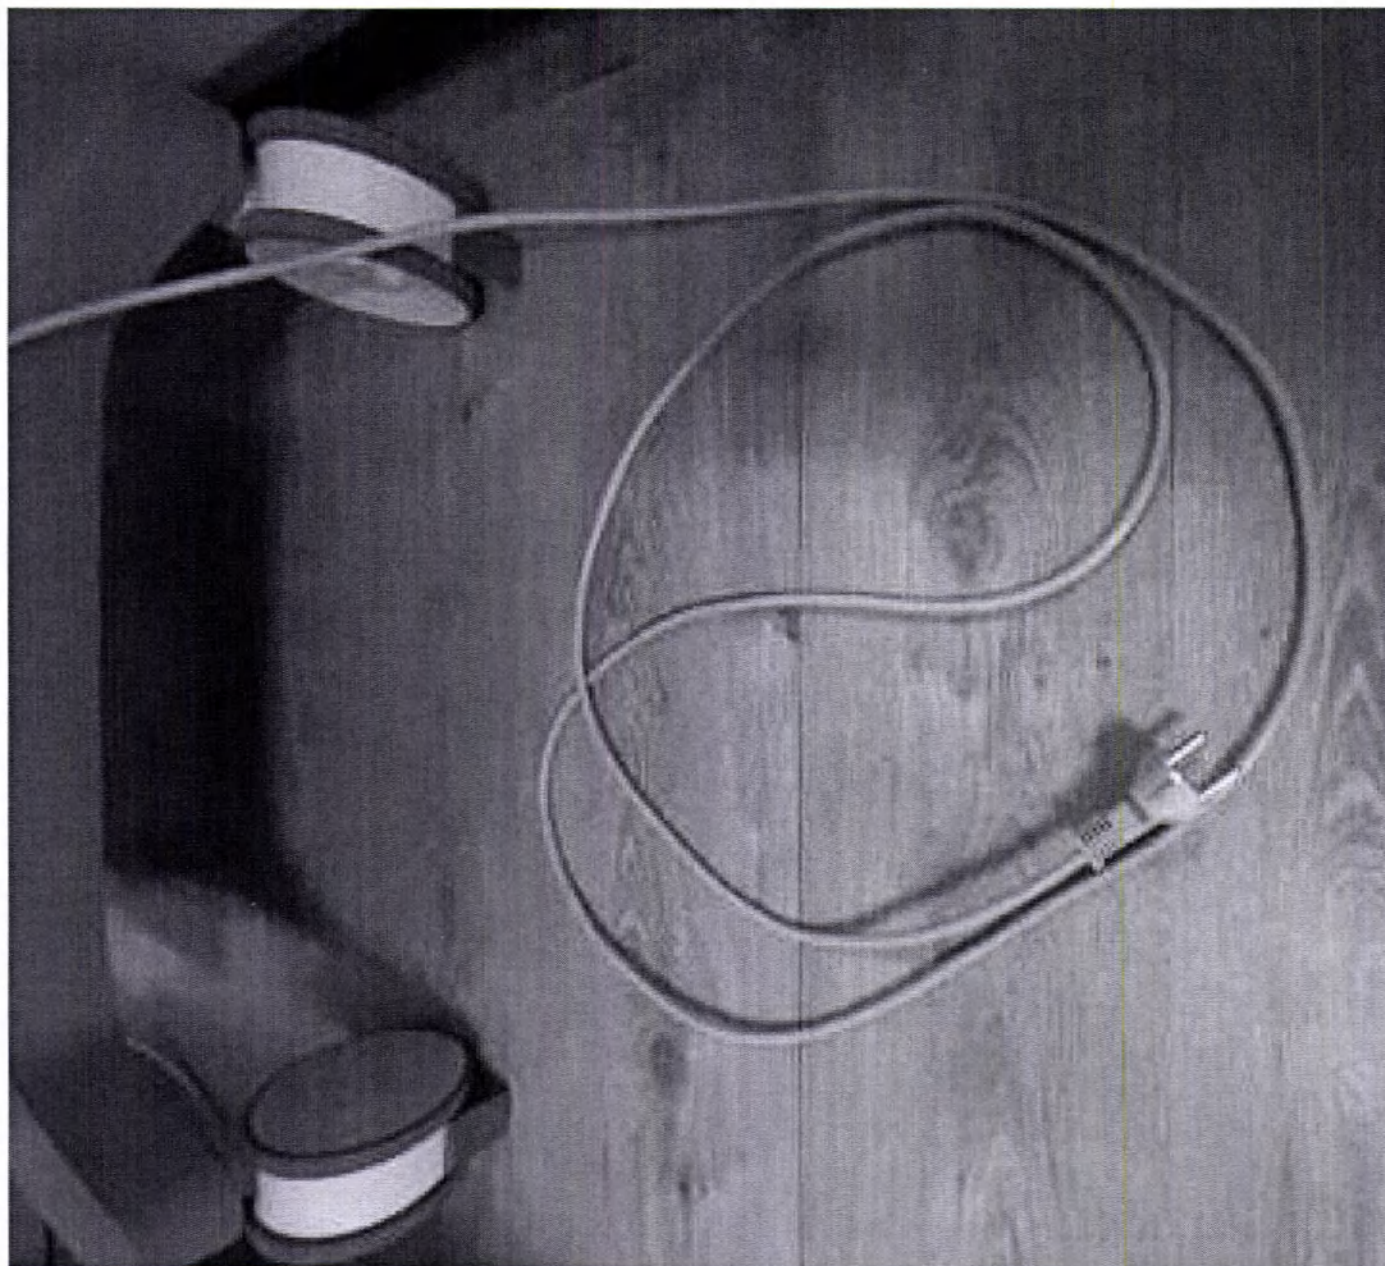


Розетки сетевые вспомогательные.

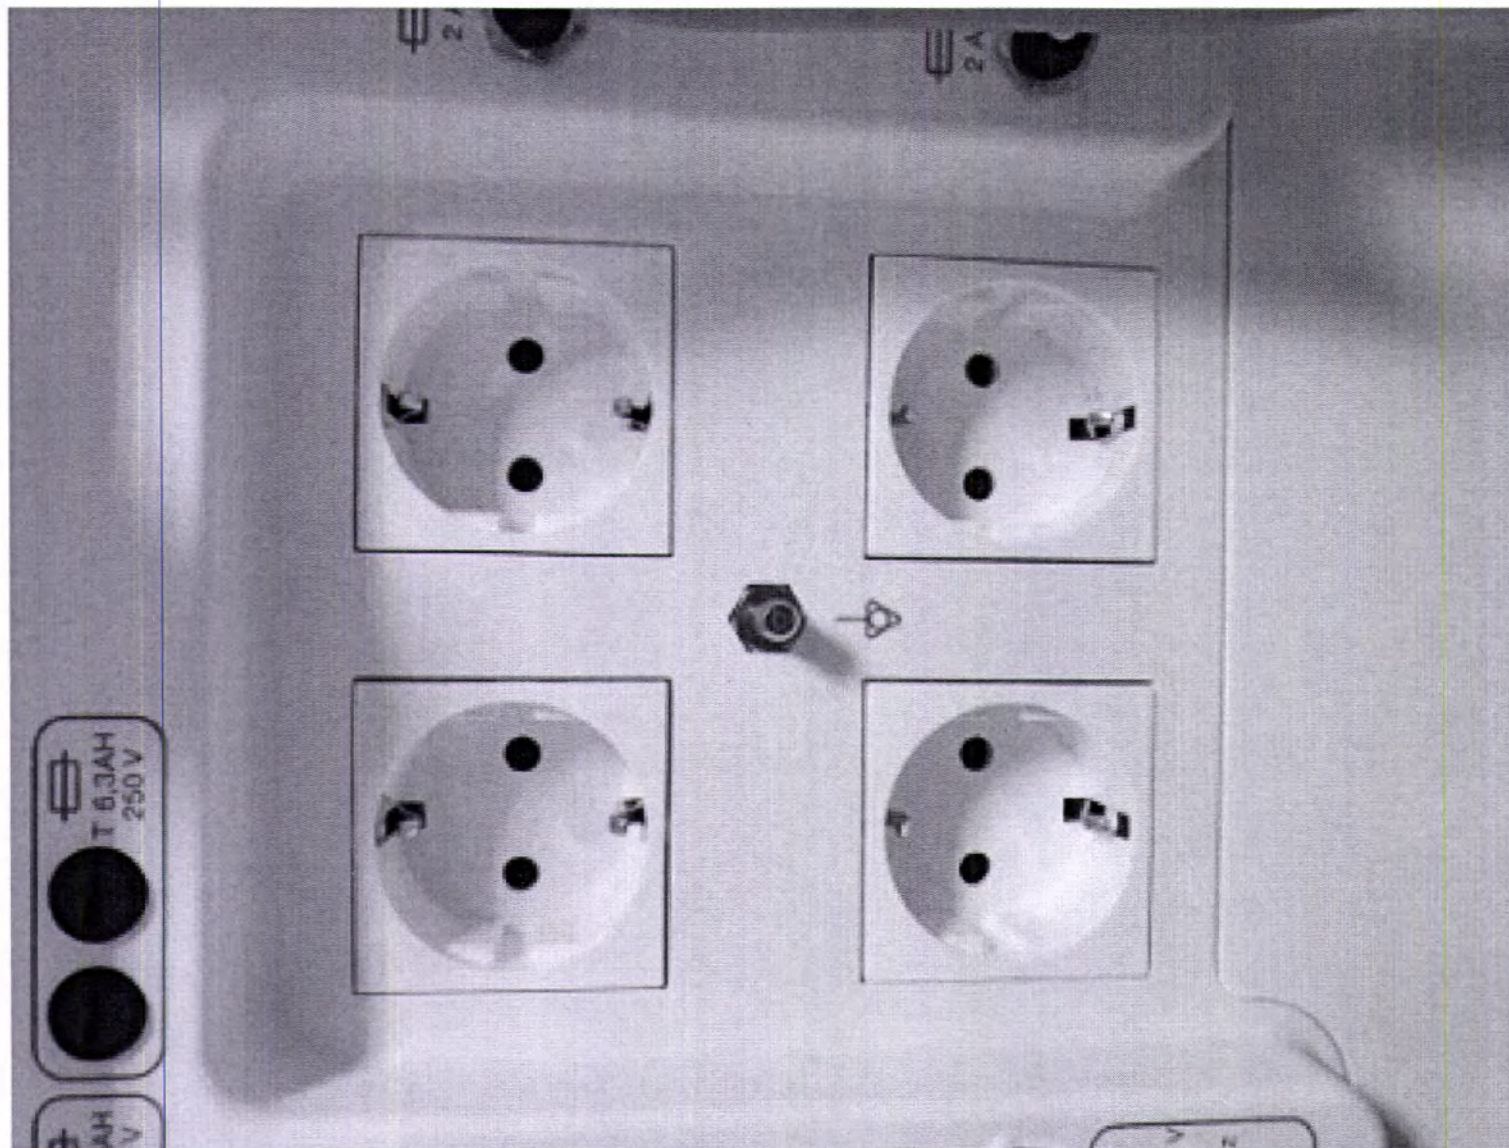


Стол письменный.

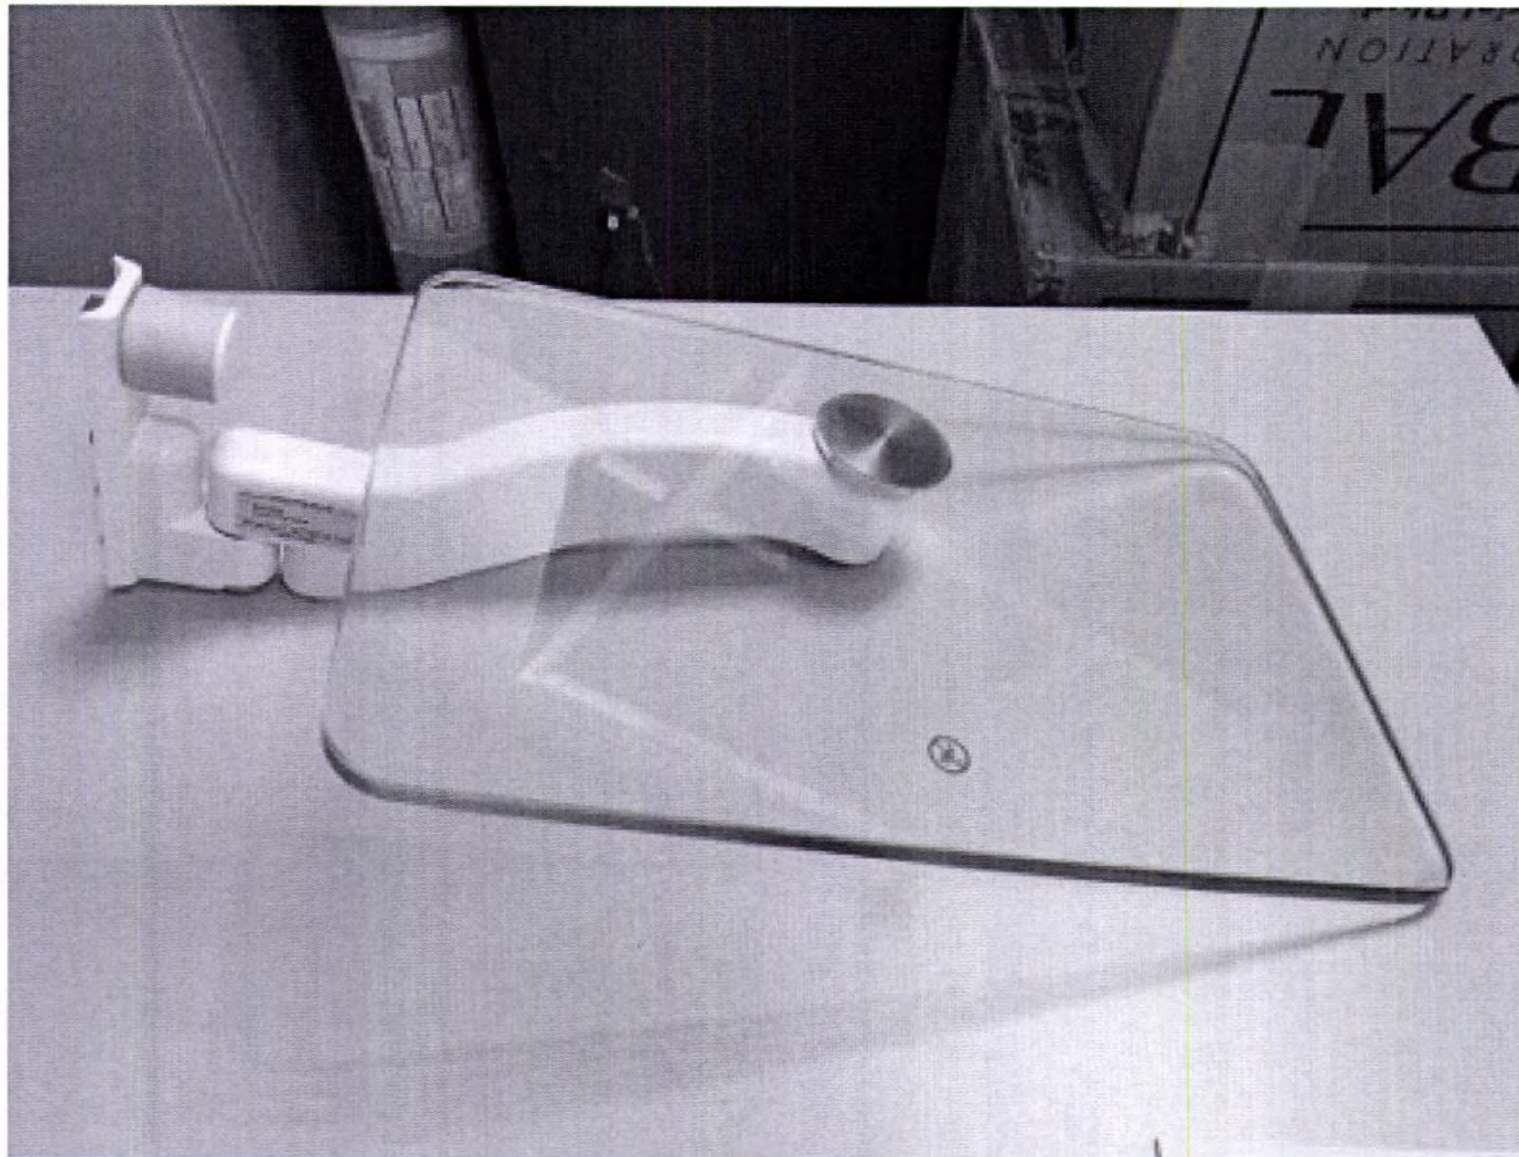


Рельса крепления дополнительного оборудования.

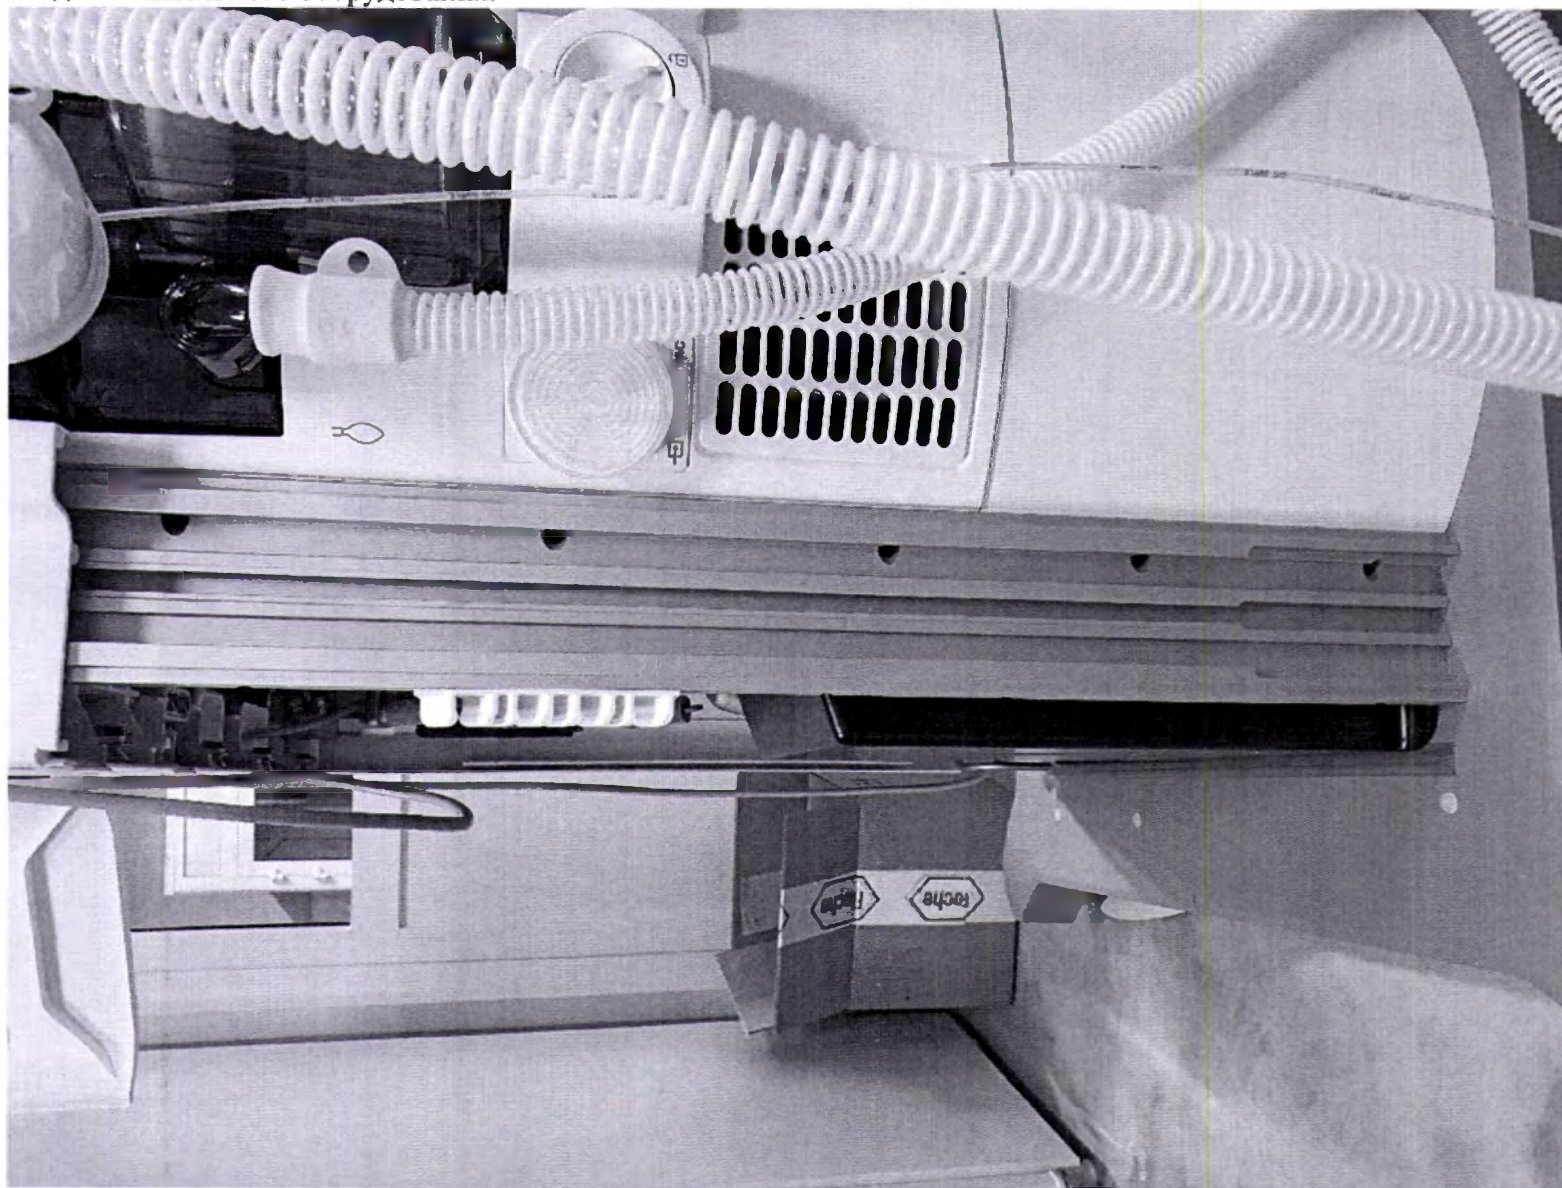


Заглушка для рельсы крепления дополнительного оборудования.

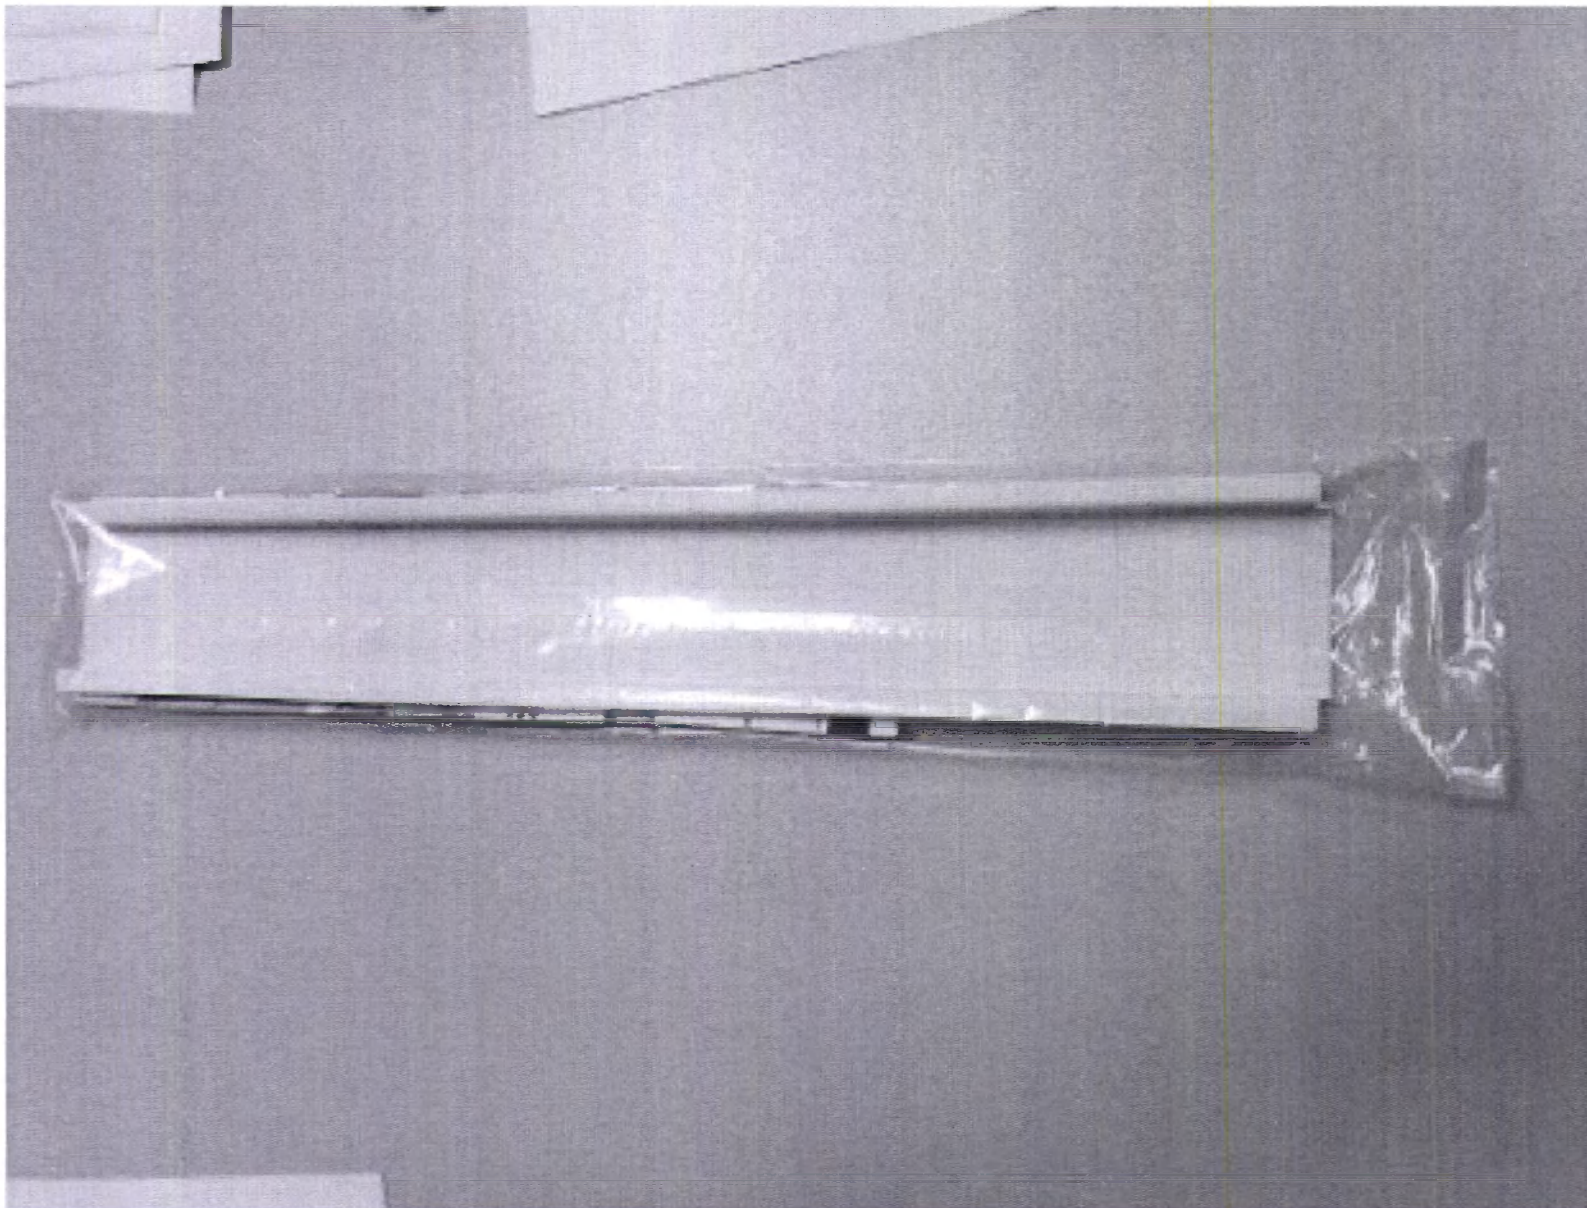

Держатель для газового баллона.

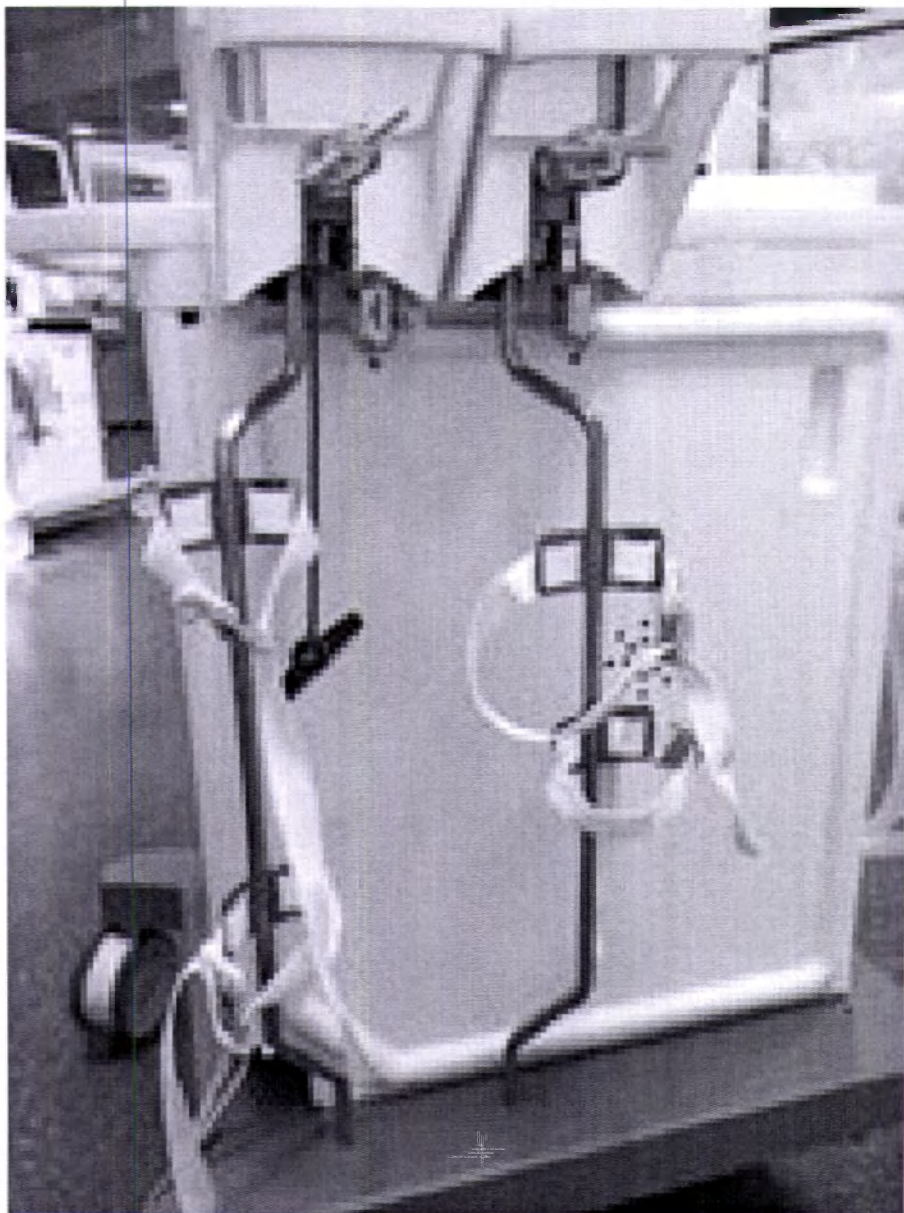

DIN-рейка для баллона.

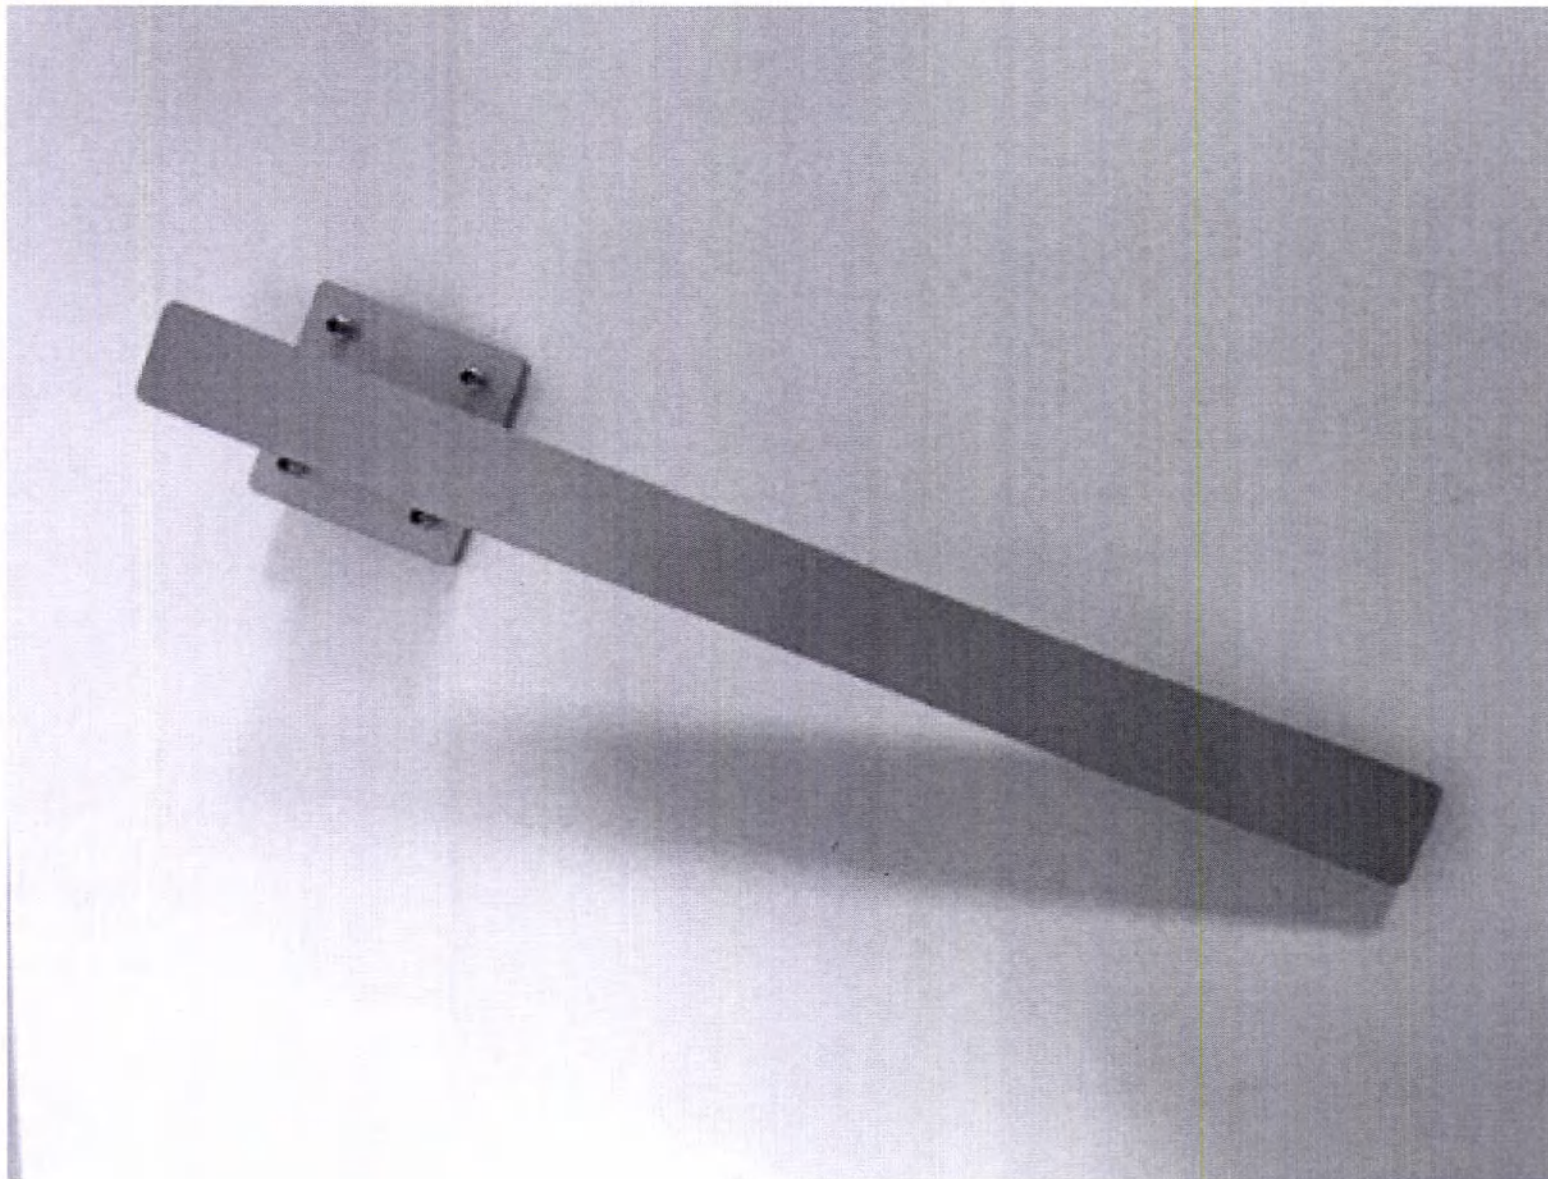


Разъем дополнительной подачи газа (при необходимости).




Набор принадлежностей для разъема дополнительной подачи газов, не более 10 шт. (при необходимости):



- Адаптер;
- Резинка уплотнительная кольцевая;
- Наклейка, не более 2 шт.

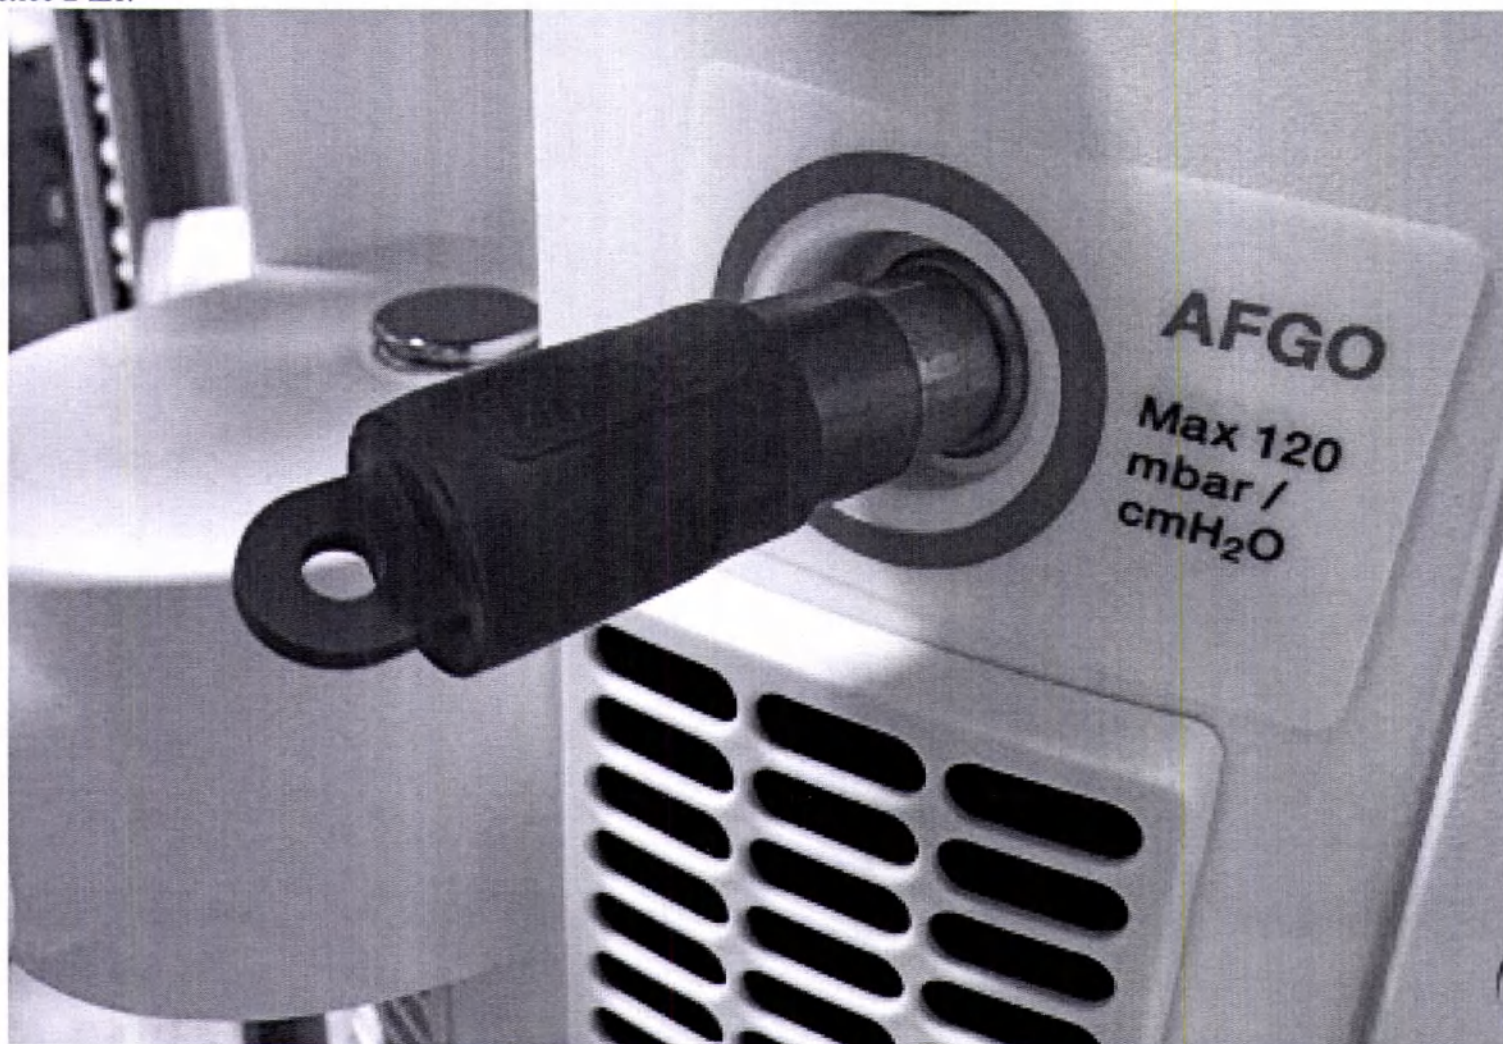


Фильтр вирусно-бактериальный одноразовый.

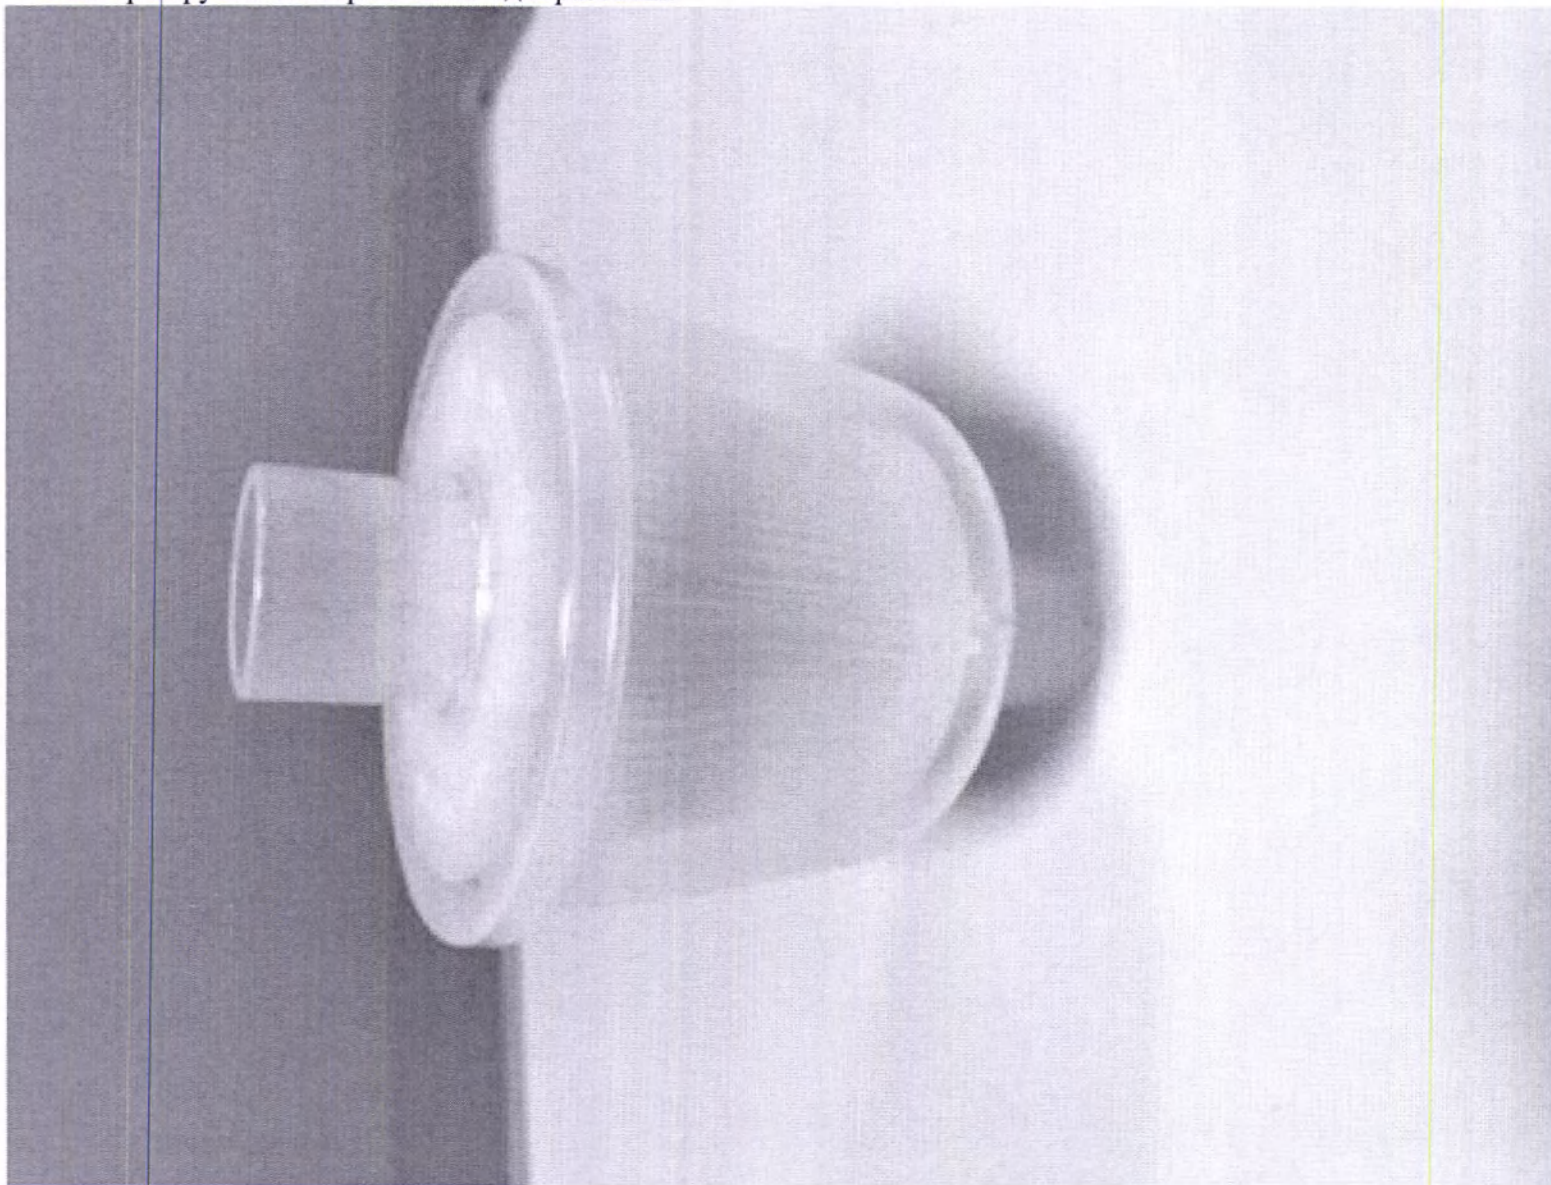


Адаптер дыхательного контура, варианты: прямой, изогнутый.

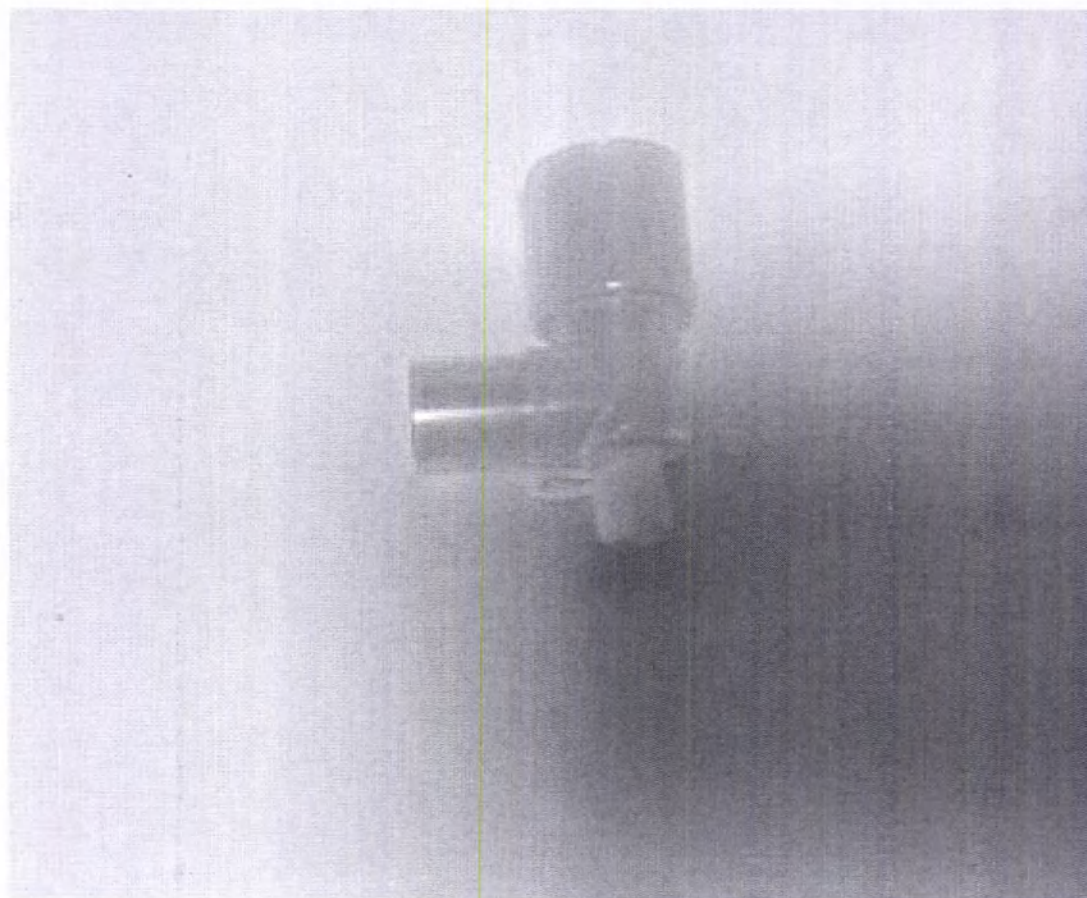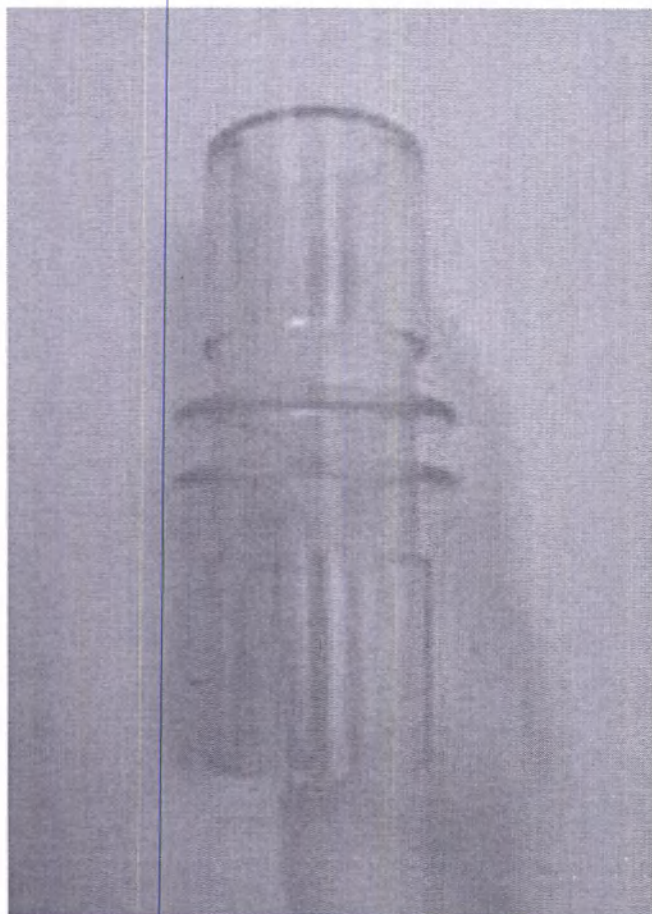


Модуль батарейный.

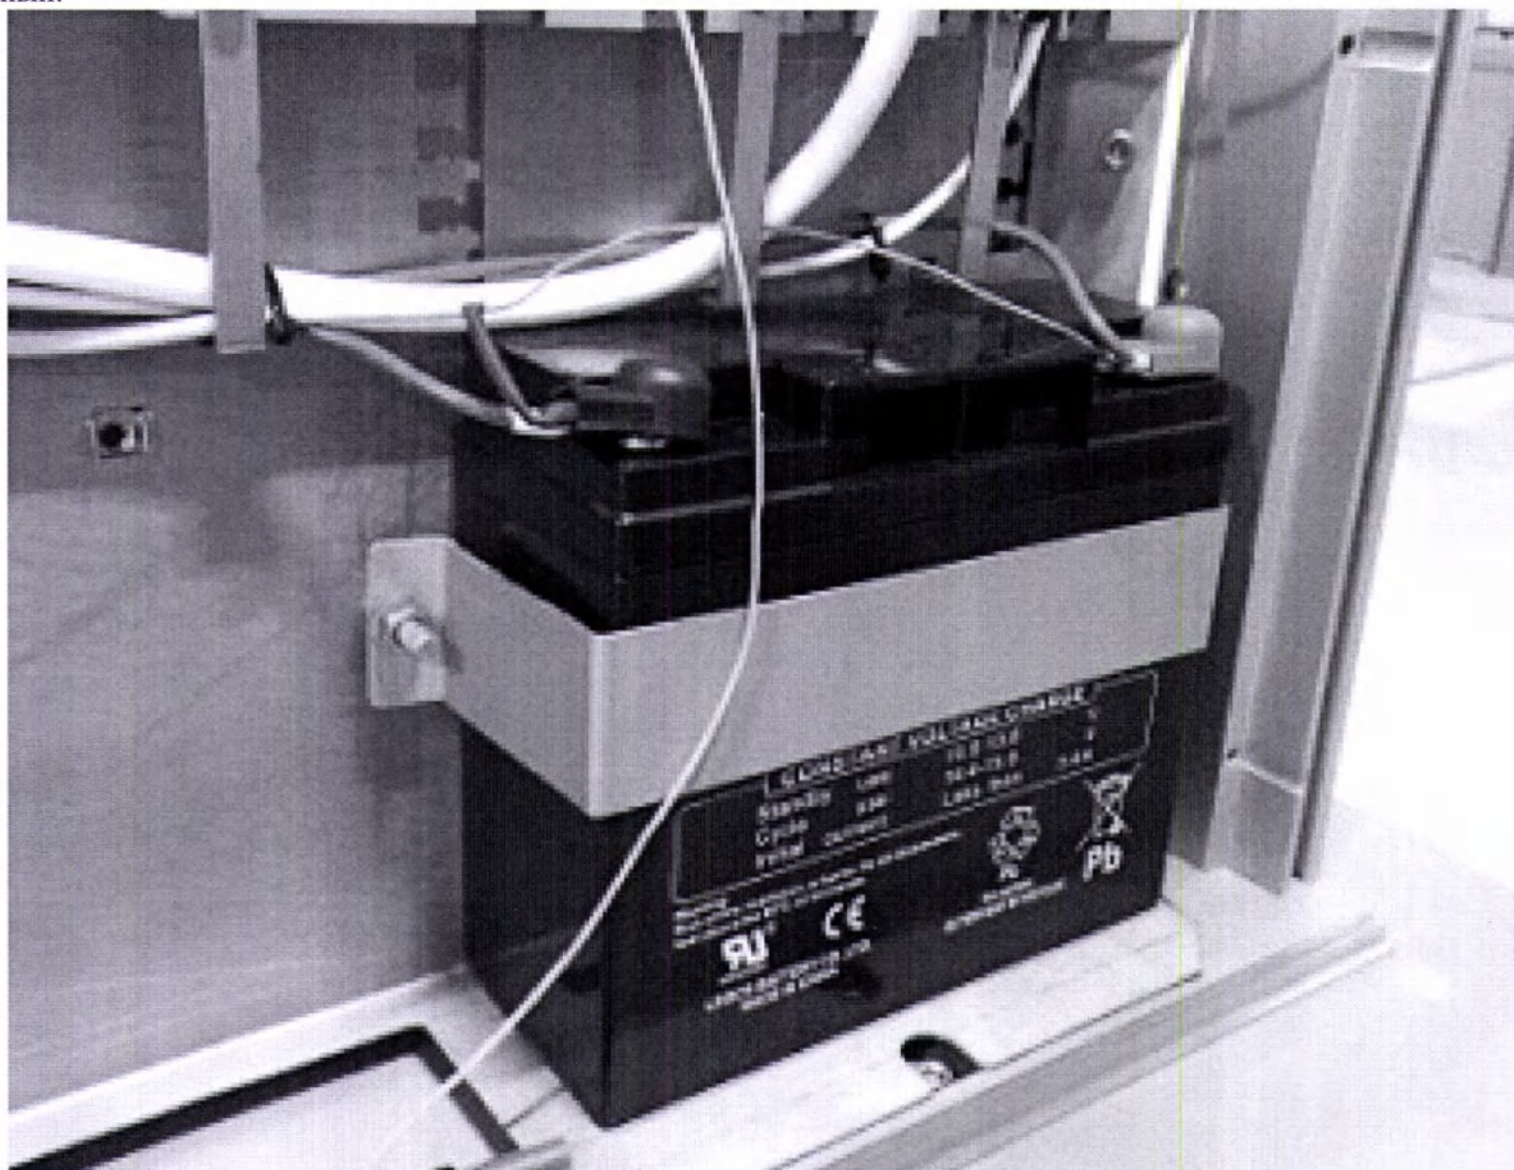


Тестовое легкое.

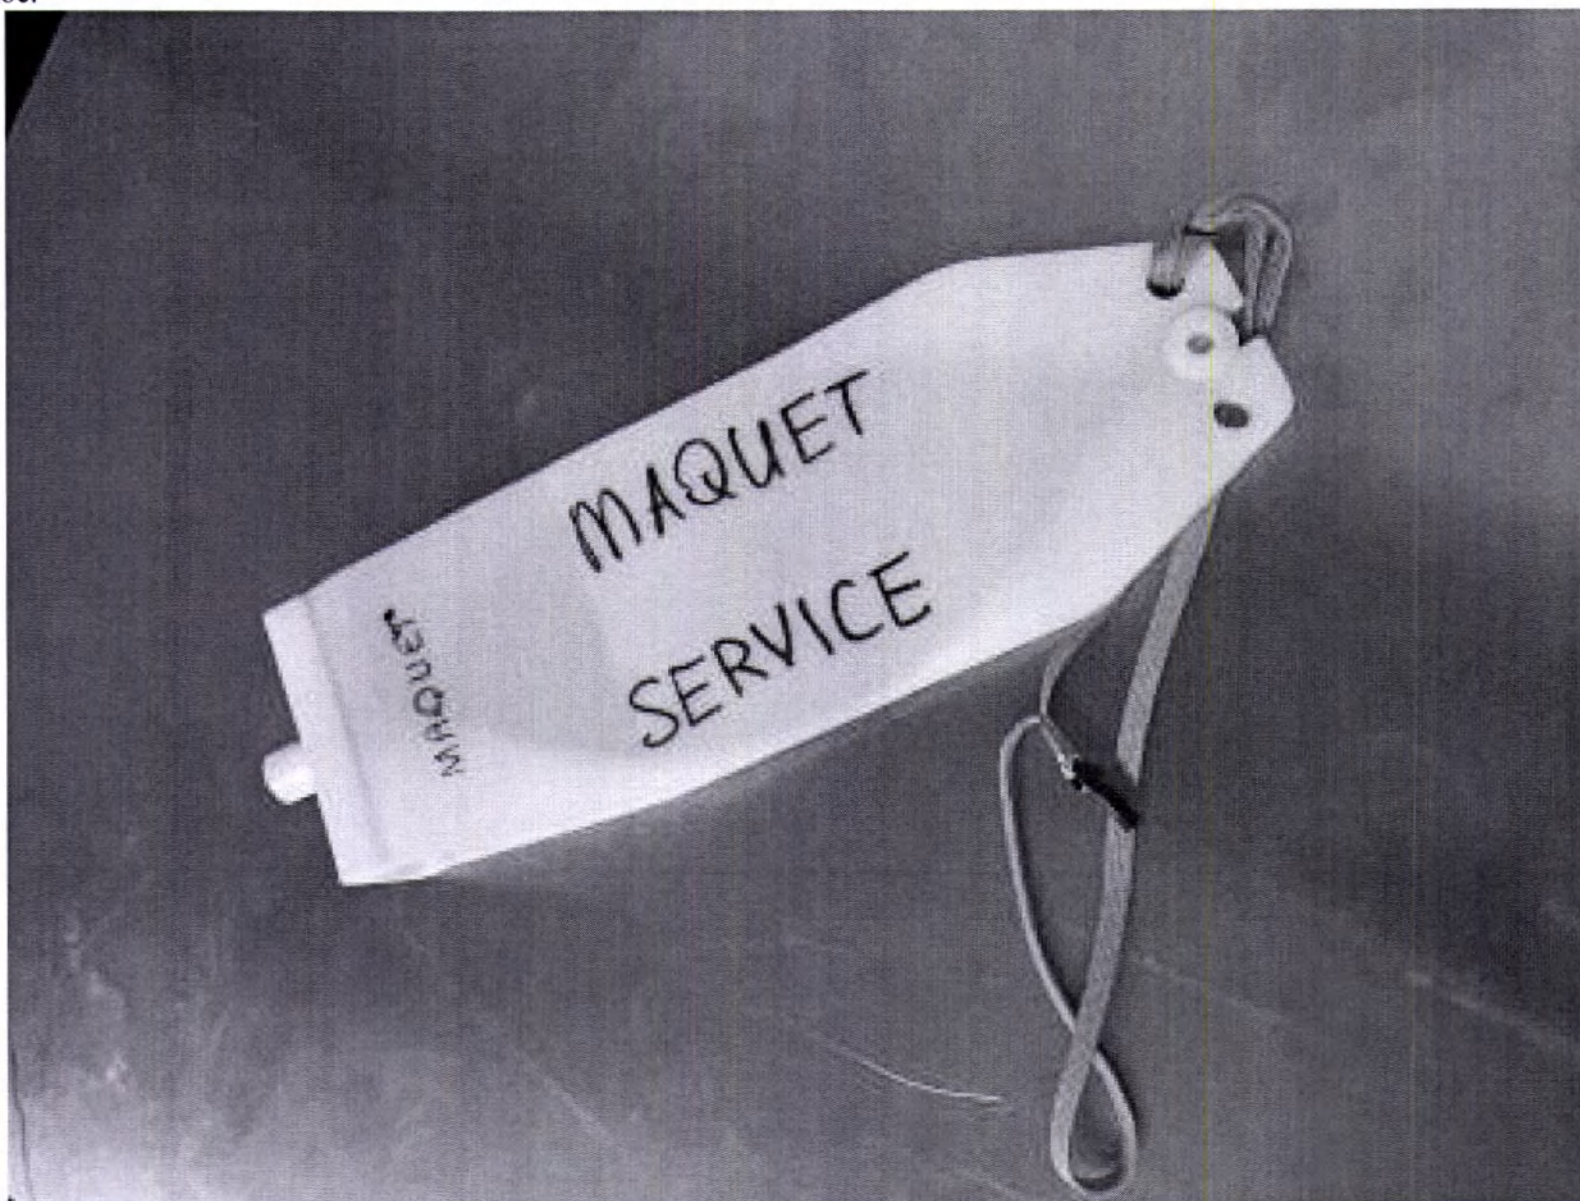

Мешок дыхательный одноразовый, объемом 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л, 3,0 л.

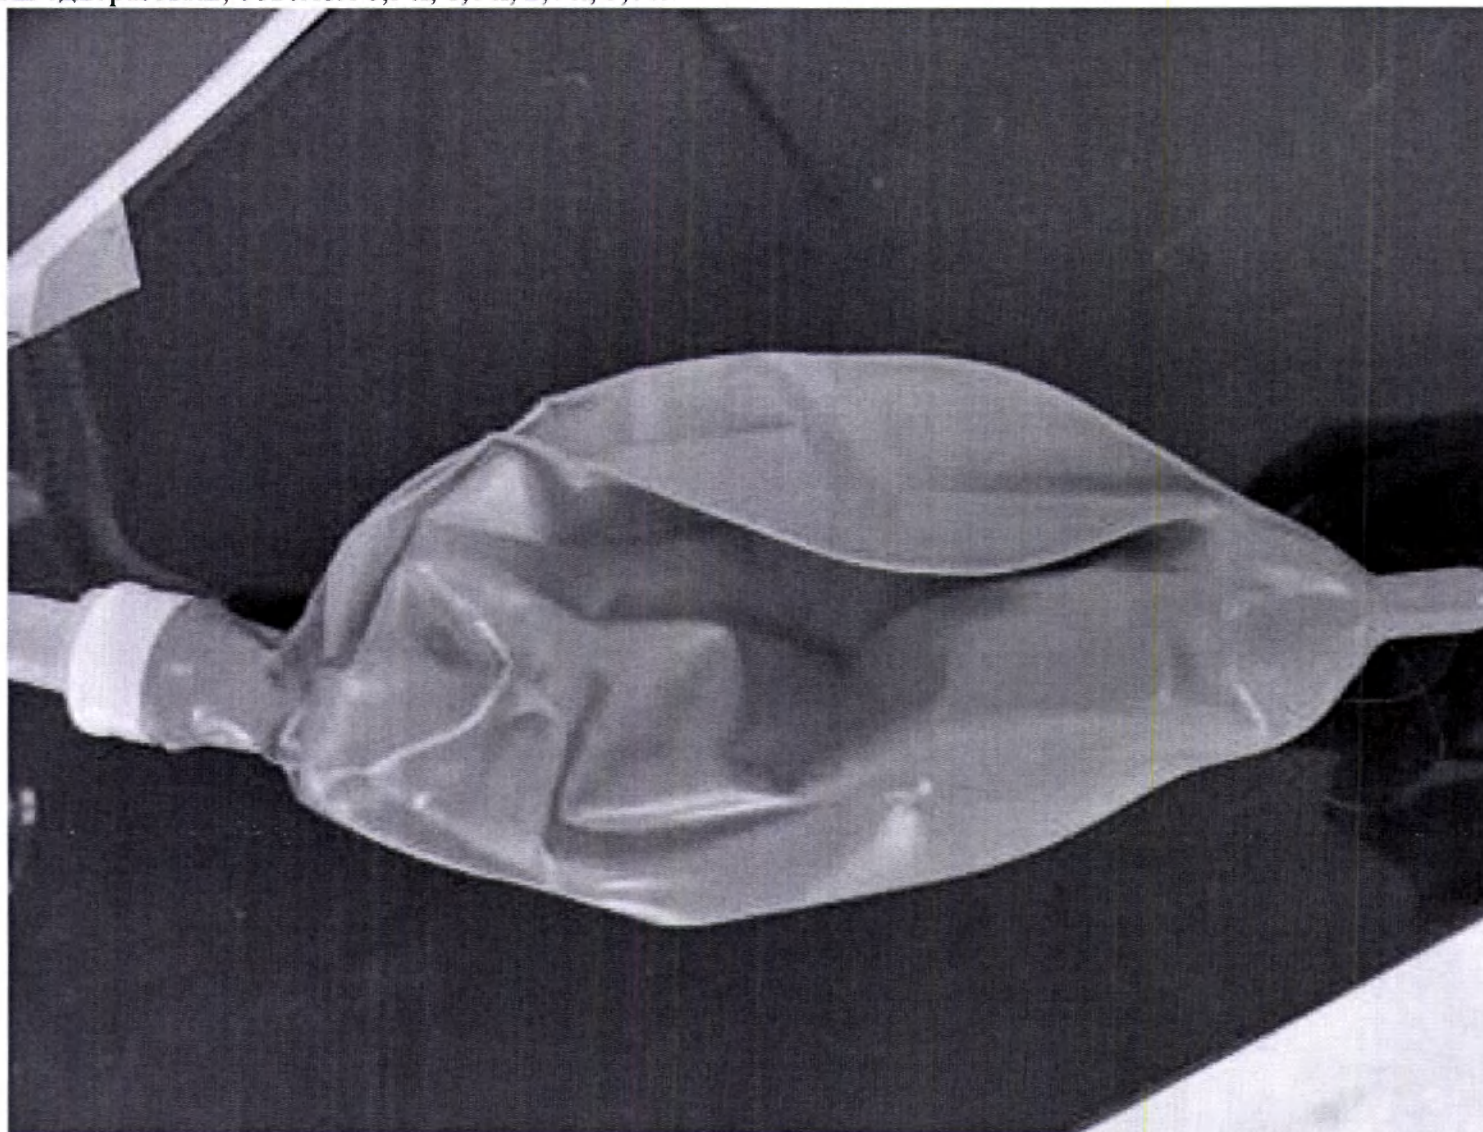

Мешок дыхательный многоразовый, объемом 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л, 3,0 л.

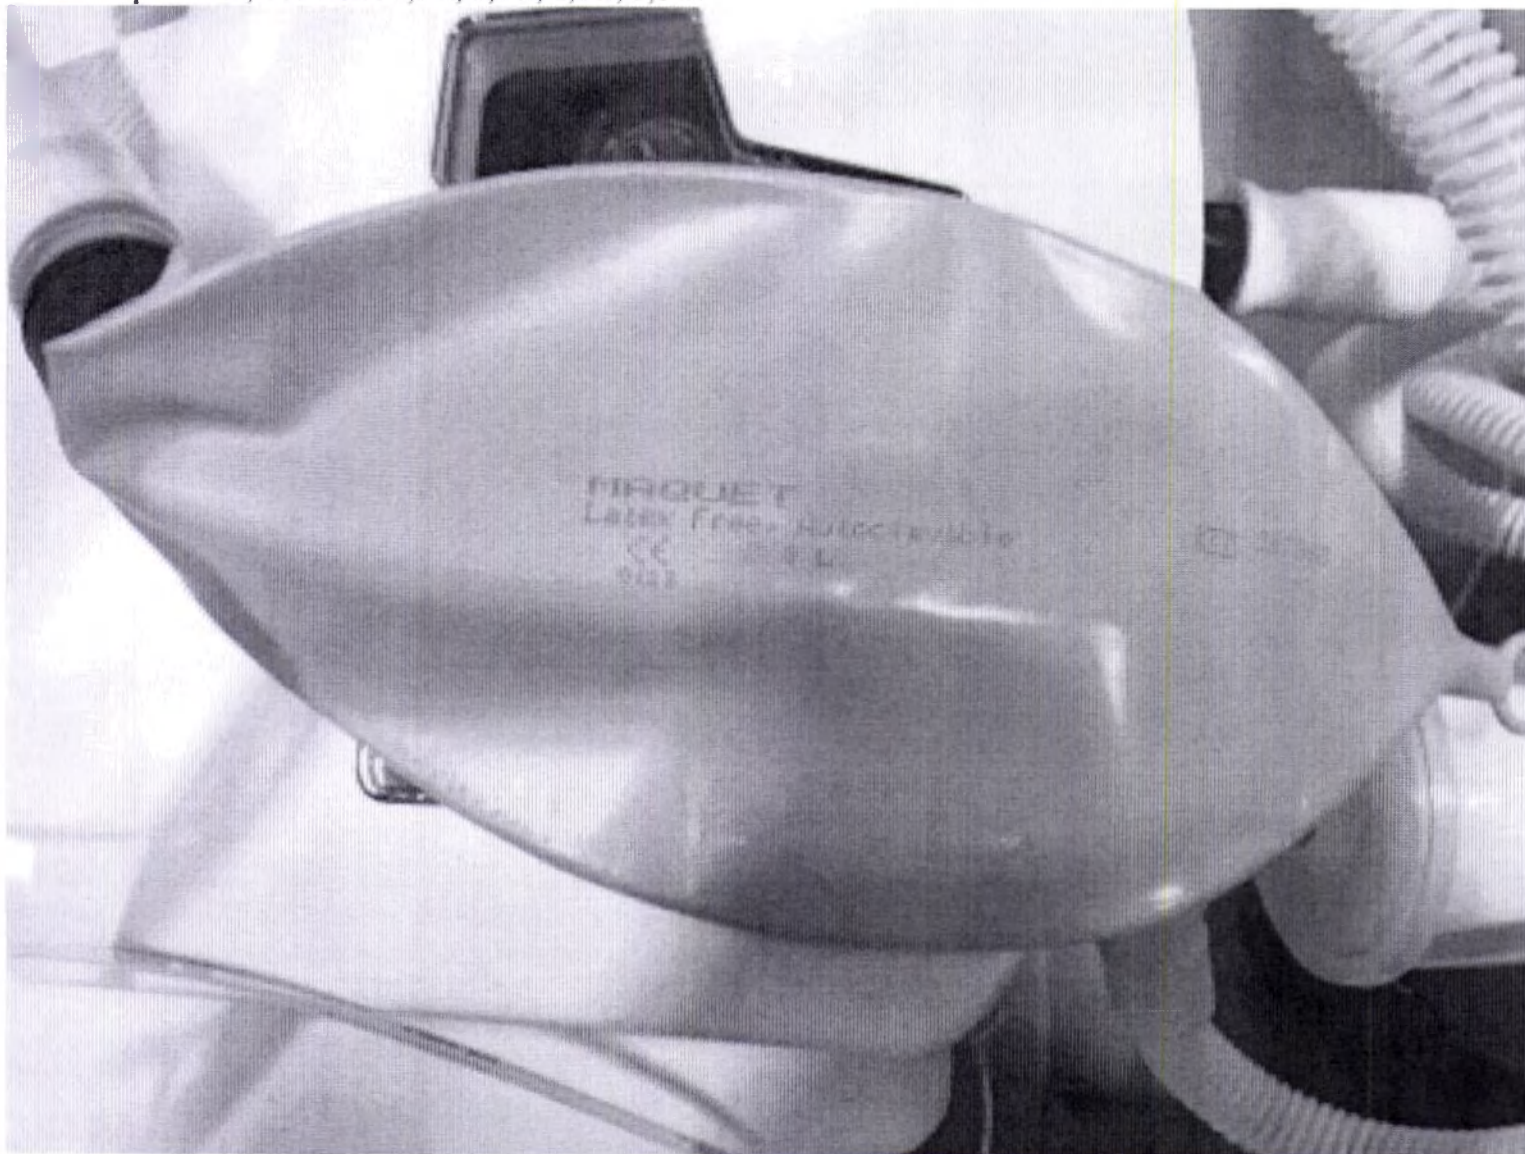

Макет маркировки системы анестезиологической Flow-c на русском языке.



«Маке Критикал Кза АБ», Швеция
(*Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 2, SE-171 54
Solna, SWEDEN)

Наименование МИ: Система анестезиологическая Flow-c

Заводской номер:

см.  на маркировке

Дата изготовления: см.  на маркировке

Электропитание: см. 

Предупреждения и знаки опасности:

см. 

РУ номер:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Маке»
109004, Россия, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Тел.: +7(495)514 00 55

Система анестезиологическая Flow-c.

1. Базовый блок.
2. Панель управления.
3. Инструкция по эксплуатации, не более 4 шт.
4. Кассета пациента, не более 5 шт. (при необходимости).
5. Крышка кассеты пациента клапанная, не более 2 шт. (при необходимости).
6. Адаптер для кассеты пациента, не более 10 шт. (при необходимости).
7. Рефлектор объема, не более 5 шт. (при необходимости).
8. Блок подачи и вывода газов, не более 2 шт. (при необходимости).
9. Клапан APL регулировки предельного давления, не более 2 шт. (при необходимости).
10. Анализатор газов встроенный, (при необходимости).
11. Влагуловитель, не более 100 шт. (при необходимости).
12. Линия отбора проб, не более 1000 шт. (при необходимости).
13. Кронштейн для панели управления, не более 3 шт. (при необходимости).
14. Кронштейн для монитора, не более 3 шт. (при необходимости).
15. Съёмная пластина кронштейна для монитора, не более 3 шт. (при необходимости).
16. Кронштейн для оборудования, не более 10 шт. (при необходимости).
17. Штатив, не более 3 шт. (при необходимости).
18. Крючок универсальный, не более 10 шт. (при необходимости).
19. Держатель адаптера крюка, не более 3 шт. (при необходимости).
20. Держатель рельсы, не более 3 шт. (при необходимости).
21. Держатель мешка для ручной вентиляции, не более 5 шт. (при необходимости).
22. Держатель кабелей, не более 5 шт. (при необходимости).
23. Держатель шлангов пациента, не более 3 шт. (при необходимости).
24. Ящик, не более 3 шт. (при необходимости).
25. Вставка с замком в ящик, не более 3 шт. (при необходимости).
26. Разделитель для ящика, не более 3 шт. (при необходимости).
27. Набор адаптеров для очистки кассеты пациента, не более 2 шт. (при необходимости).
28. Испаритель для изофлюрана не более 5 шт. (при необходимости).
29. Испаритель для севофлюрана не более 5 шт. (при необходимости).
30. Испаритель для десфлюрана не более 5 шт. (при необходимости).
31. Адаптер для флакона с анестезирующим агентом, не более 3 шт. (при необходимости).
32. Абсорбер углекислого газа, одноразовый, не более 12 шт. (при необходимости).
33. Ёмкость абсорбера углекислого газа, многоразовая, не более 5 шт. (при необходимости).
34. Фильтр для ёмкости абсорбера углекислого газа, не более 120 шт. (при необходимости).
35. Блок отсасывания, (при необходимости).
36. Фильтр гидрофобный бактериальный, не более 20 шт. (при необходимости).
37. Фильтр вентилятора охлаждения, не более 10 шт. (при необходимости).
38. Шланг воздушный для компрессора, не более 3 шт. (при необходимости).
39. Шланг воздушный для подключения аппарата к магистрали, не более 3 шт. (при необходимости).
40. Шланг воздушный для подключения компрессора к аппарату, не более 3 шт. (при необходимости).
41. Шланг закиси азота со штуцерами, не более 3 шт. (при необходимости).
42. Шланг кислородный высокого давления, не более 2 шт. (при необходимости).
43. Шланг для системы эвакуации газов, не более 2 шт. (при необходимости).
44. Соединительная трубка (при необходимости).
45. Дроссель EVAC (при необходимости).
46. Программное обеспечение, в конфигурациях:
 - ПО вентиляции, управляемой по давлению (при необходимости);

- ПО вентиляции, управляемой по объему;
 - ПО вентиляции поддержка давлением/постоянного положительного давления в дыхательных путях (при необходимости);
 - ПО вентиляции, управляемой по объему с регулируемым давлением (при необходимости);
 - ПО вентиляции синхронизированной перемежающейся принудительной с поддержкой по давлению самостоятельного дыхания (при необходимости);
 - ПО дополнительного выхода свежего газа (при необходимости);
 - ПО вентиляции с низким дыхательным объемом (при необходимости);
 - ПО высокоэффективной вентиляции (при необходимости);
 - ПО режима АИК (при необходимости);
 - ПО задержка дыхания на вдохе/задержка дыхания на выдохе (при необходимости);
 - ПО «расчета массы тела» (при необходимости);
 - ПО использования анестезирующего агента (при необходимости).
 - ПО функции N₂O
47. Дыхательный контур детский, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента 2 шт.;
 - Патрубок Y-образный пластиковый;
 - Адаптер.
48. Дыхательный контур для новорожденных, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента 2 шт.;
 - Патрубок угловой Y-образный пластиковый
49. Дыхательный контур взрослый, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента 2 шт.;
 - Патрубок Y-образный пластиковый;
 - Адаптер.
50. Дыхательный контур для взрослых одноразовый, не более 200 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для взрослых 3шт;
 - Мешок дыхательный;
 - Y-образный патрубок;
 - Адаптер;
 - Трубка газовая пробоотборная.
51. Дыхательный контур для новорожденных одноразовый, не более 200 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для новорожденных, 3 шт.;
 - Мешок дыхательный;
 - Y-образный патрубок;
 - Адаптер;
 - Трубка газовая пробоотборная.
52. Дыхательный контур для детей одноразовый, не более 200 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для детей, 3 шт.;
 - Мешок дыхательный;
 - Y-образный патрубок;
 - Адаптер;
 - Трубка газовая пробоотборная.
53. Дыхательный контур для новорожденных многоразовый, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для новорожденных;
 - Мешок дыхательный;
 - Адаптер.

54. Дыхательный контур для взрослых многоразовый, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для взрослых;
 - Мешок дыхательный;
 - Адаптер.
55. Дыхательный контур для детей многоразовый, не более 100 шт. (при необходимости):
- Трубка пациента для детей;
 - Мешок дыхательный;
 - Адаптер.
56. Компрессор Mini (при необходимости):
- Сливной флакон;
 - Кабель сетевой электрический;
57. Маски анестезиологические многоразовые, размеры 0, 1, 2, 3, 4, 5, не более 50 шт. (при необходимости).
58. Кабель питания, не более 3 шт.
59. Розетки сетевые вспомогательные, не более 15 шт. (при необходимости).
60. Стол письменный, не более 2 шт. (при необходимости).
61. Рельса крепления дополнительного оборудования, не более 10 шт. (при необходимости).
62. Заглушка для рельсы крепления дополнительного оборудования, не более 10 шт. (при необходимости).
63. Держатель для газового баллона, не более 2 шт. (при необходимости).
64. DIN-рейка для баллона, не более 5 шт. (при необходимости).
65. Разъем дополнительной подачи газа (при необходимости).
66. Набор принадлежностей для разъема дополнительной подачи газов, не более 10 шт. (при необходимости):
- Адаптер;
 - Резинка уплотнительная кольцевая;
 - Наклейка, не более 2 шт.
67. Фильтр вирусно-бактериальный одноразовый, не более 600 шт. (при необходимости).
68. Адаптер дыхательного контура, варианты: прямой, изогнутый, не более 20 шт. (при необходимости).
69. Модуль батарейный, не более 10 шт. (при необходимости).
70. Тестовое легкое, не более 10 шт. (при необходимости).
71. Мешок дыхательный одноразовый, объемом 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л, 3,0 л, не более 20 шт. (при необходимости).
72. Мешок дыхательный многоразовый, объемом 0,5 л, 1,0 л, 2,0 л, 3,0 л, не более 20 шт. (при необходимости).

Промыло, прокушено 70 шовов.

