




Фотографические изображения медицинского изделия

Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа или носоглотки человека иммунохроматографическим методом «Экспресс-тест Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)»



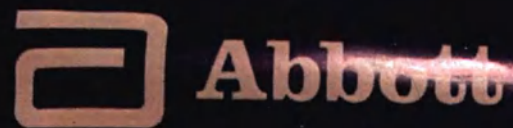

Panbio™
COVID-19 Ag
RAPID TEST DEVICE

REF 41FK1-P2




Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlaweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

2°C 30°C
36°F 86°F



буфер - 1 флакон (9 мл./фл.)

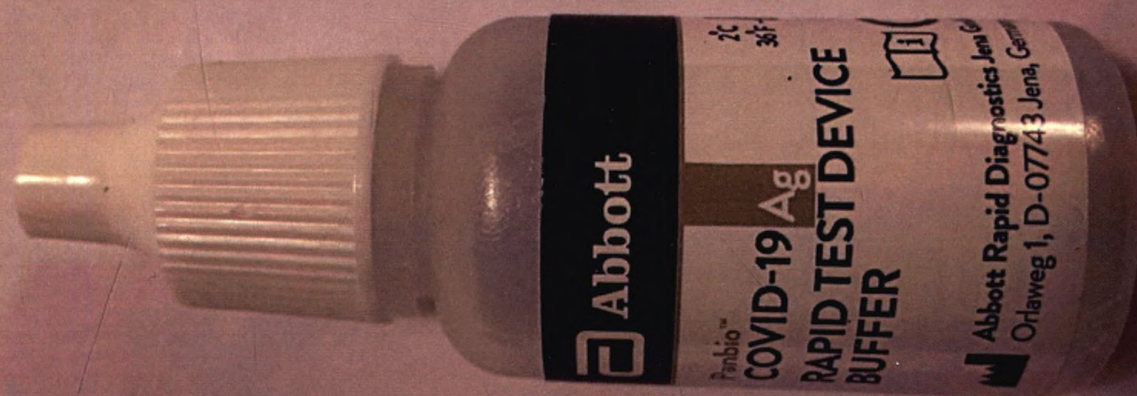

EXTRACTION TUBES

QUANTITY : 25 PCS
CAT. NO. : P78-010/011
LOT NO. : D2006001




AIM Inc.
101-903, Digital Empire II, Simwon-ro 88
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, 16681

EXTRACTION TUBE CAPS

QUANTITY : 25 PCS


CAT. NO. : P78-010/011

LOT NO. : D2011AA



DONG SUNG PRECISION CO., LTD.

A-dong, 117 Hwasan-ro, Idong-eup,
Chorwon-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea



Panbio™
COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE
Positive Control CONTROL +

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlaueg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

2°C 30°C
36°F 86°F



IVD

REF

41FK1-PC

41F1-PC-FA-A1

LOT NO.
EXP DATE
MAY 2023

41FK1-PC
2023.09.09



CONTROL USE ONLY
DO NOT USE for
specimen collection



Panbio™
COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE
Negative Control CONTROL -

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlaueg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

2°C 30°C
36°F 86°F



IVD

REF

41FK1-NC


41F1-NC-FA-A1

LOT NO.
EXP DATE
MAY 2023

41FK1-NC
2023.09.17




CONTROL USE ONLY
DO NOT USE for
specimen collection

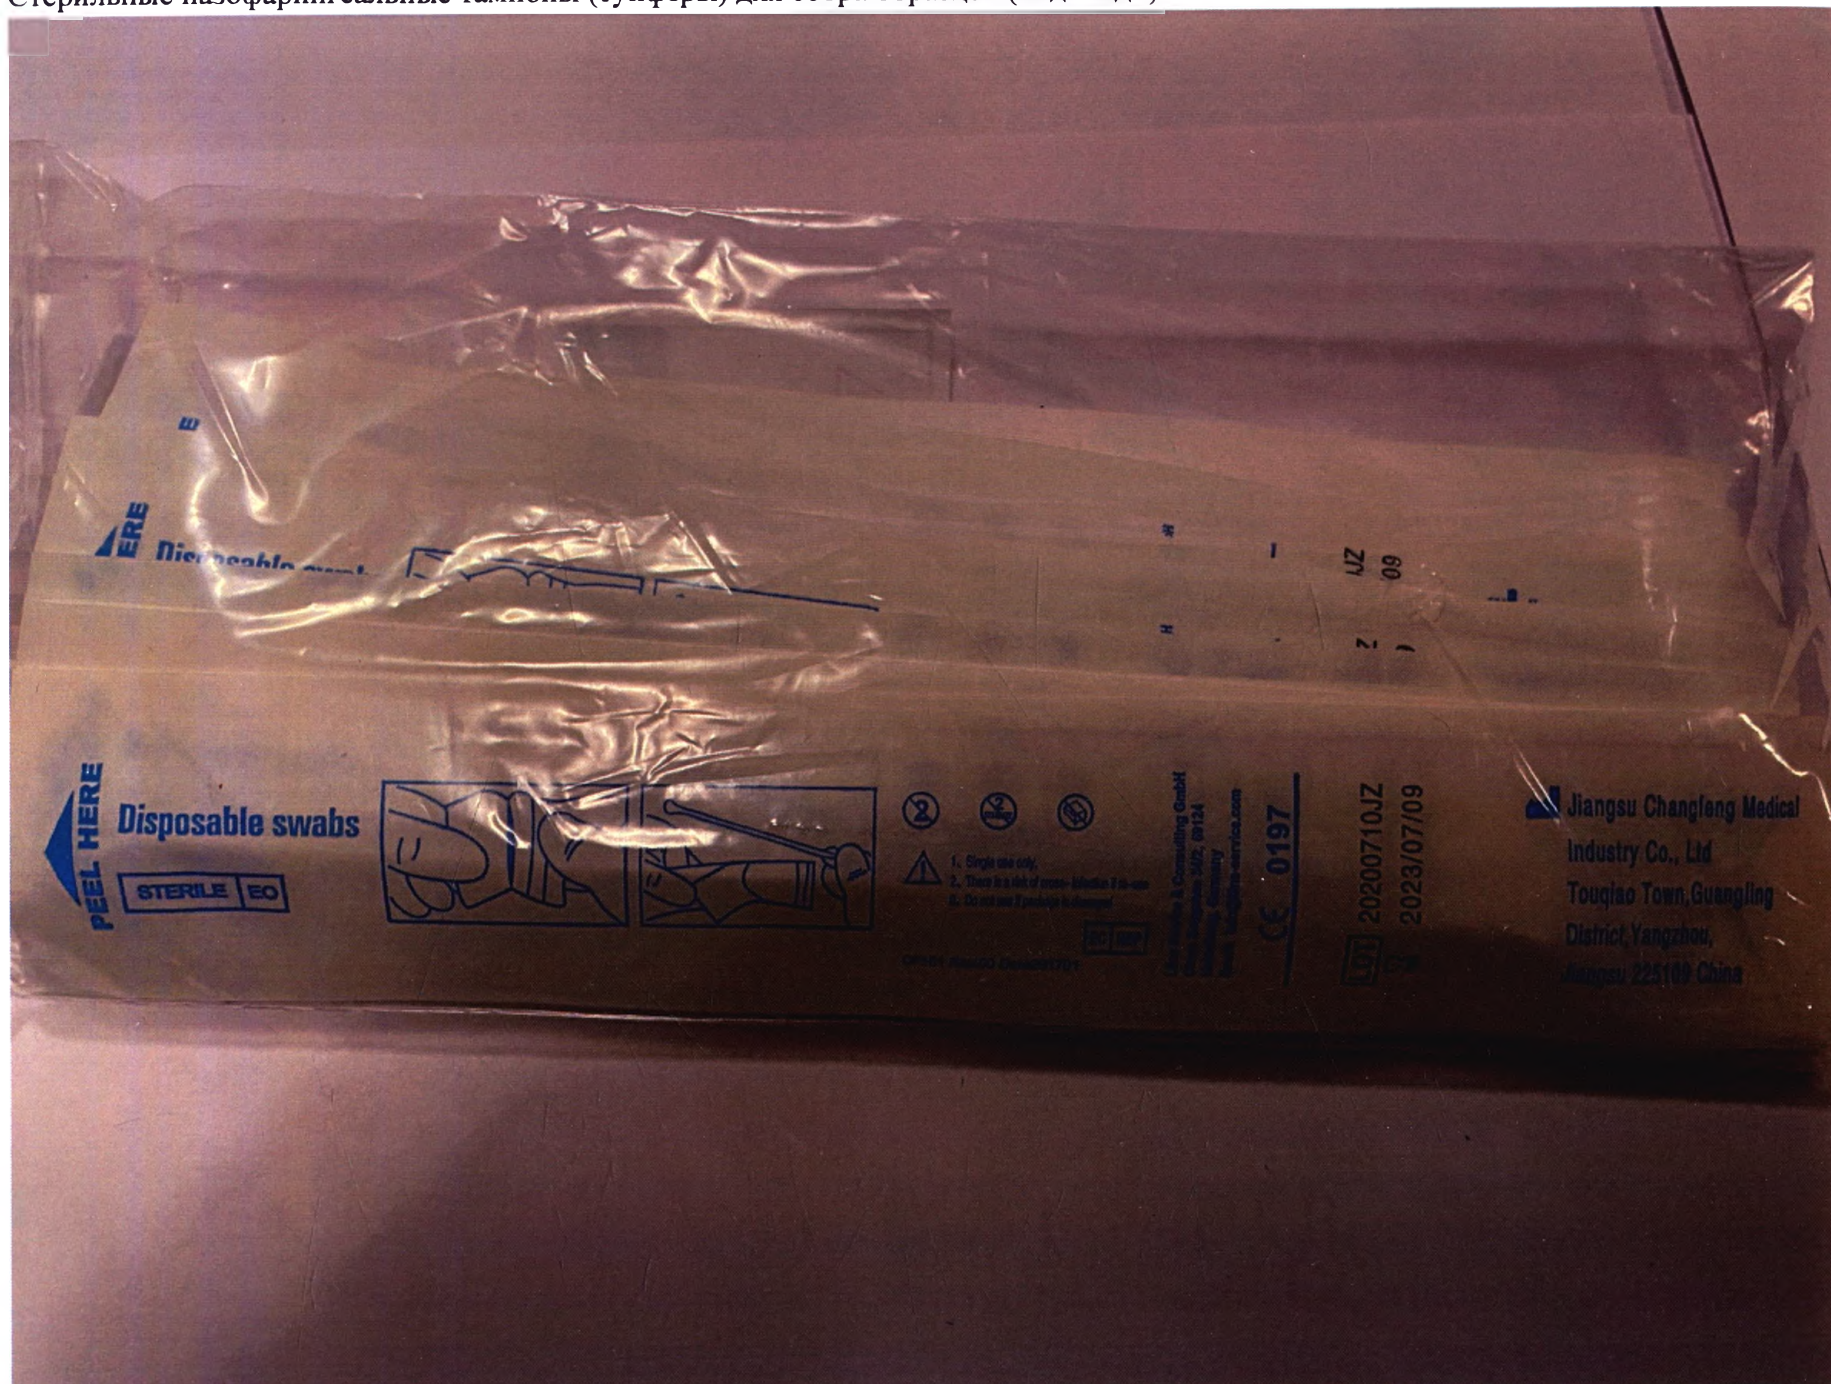


NASOPHARYNGEAL SWAB

QUANTITY : 25 PCS





NPS-R0

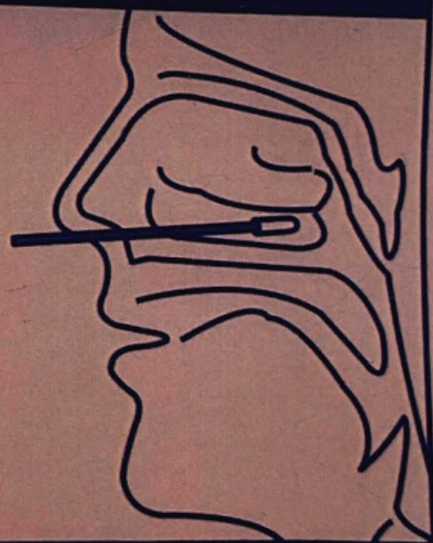


Стерильный назофарингеальный тампон (тупфер) для сбора образцов (вид спереди)



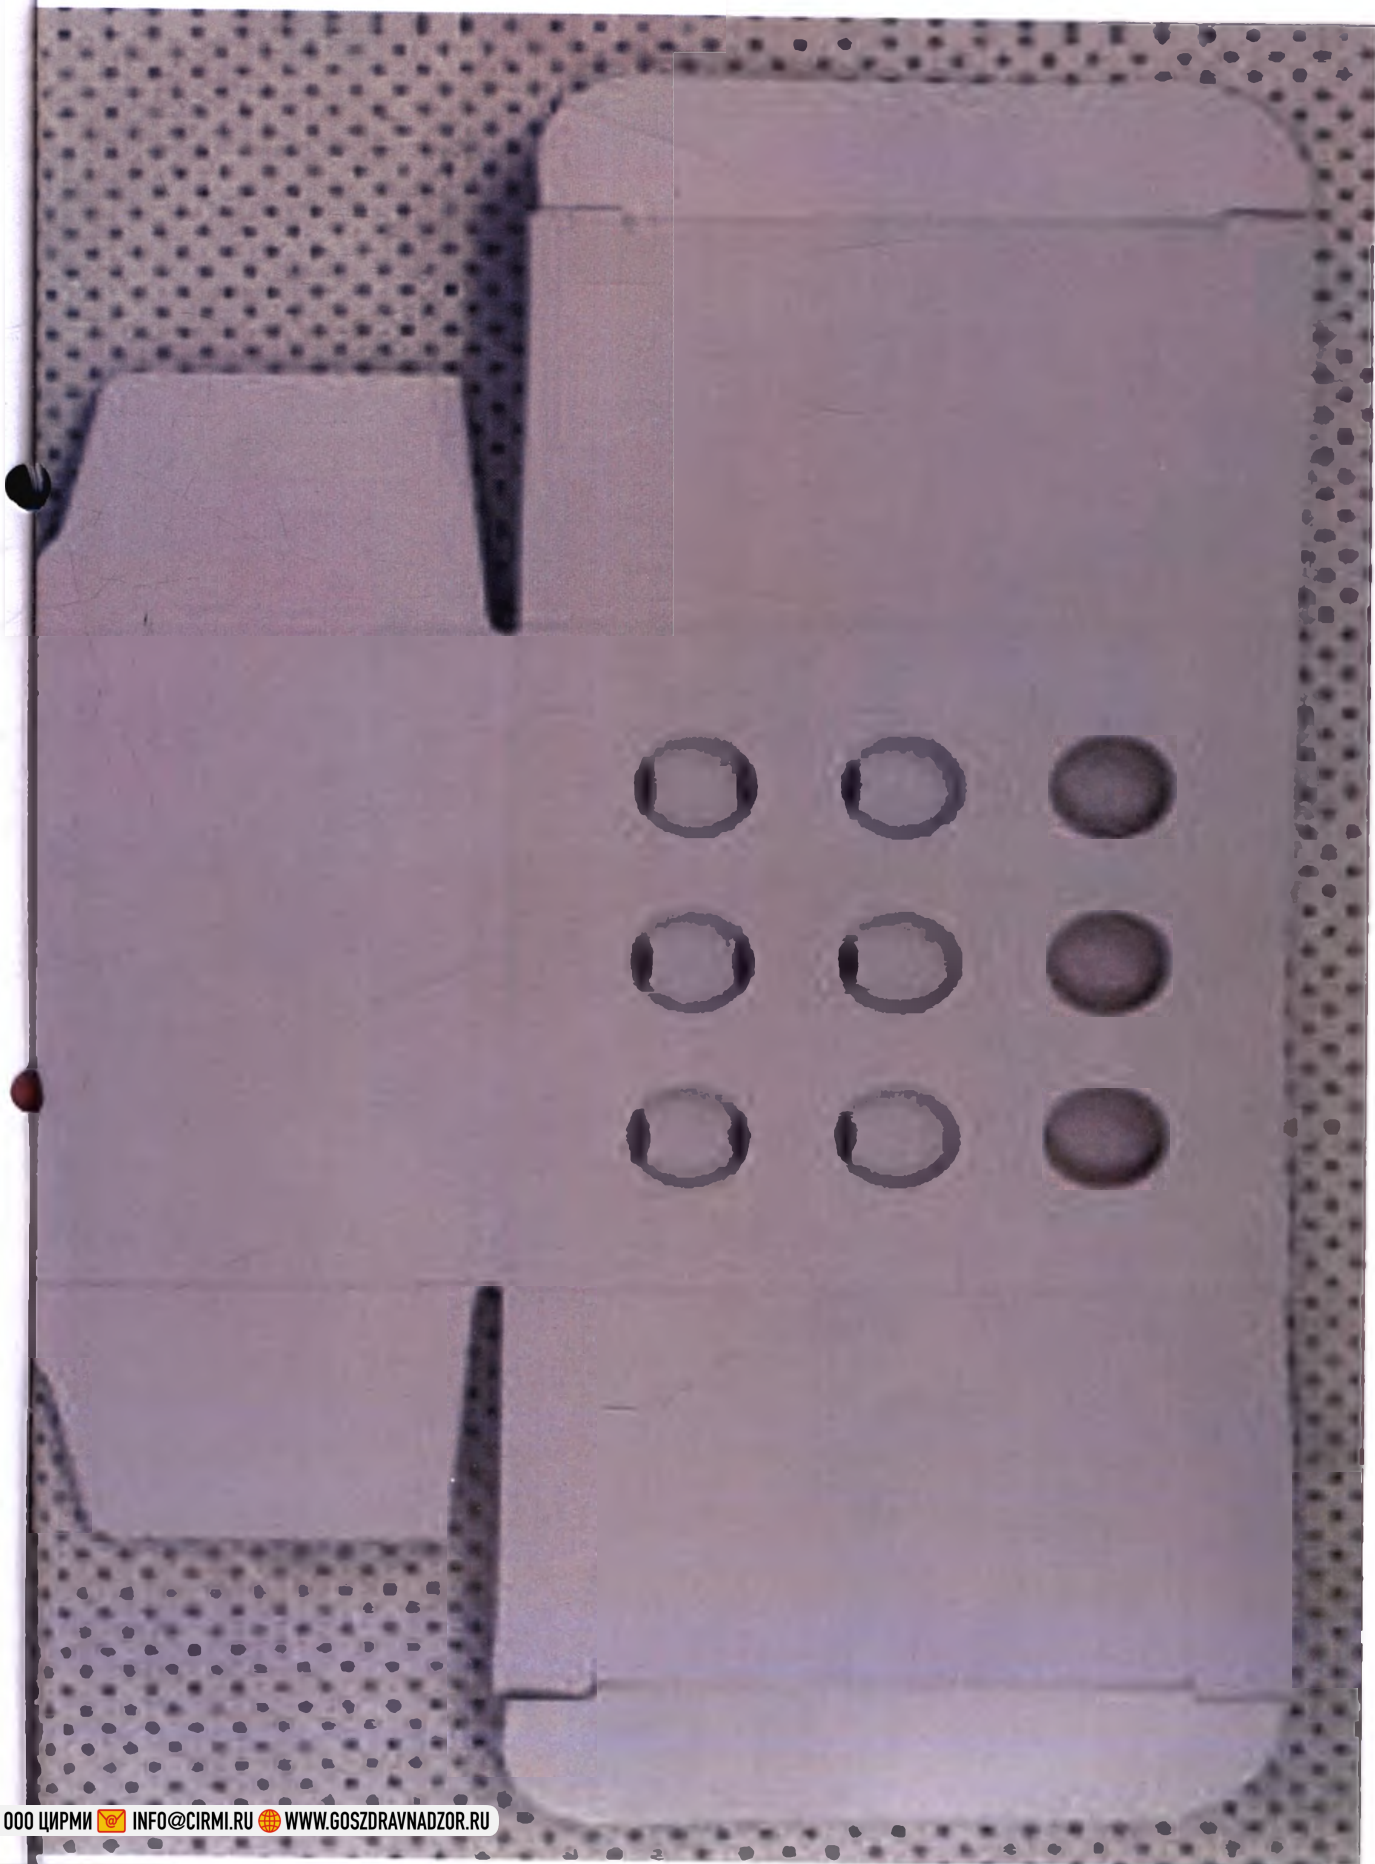

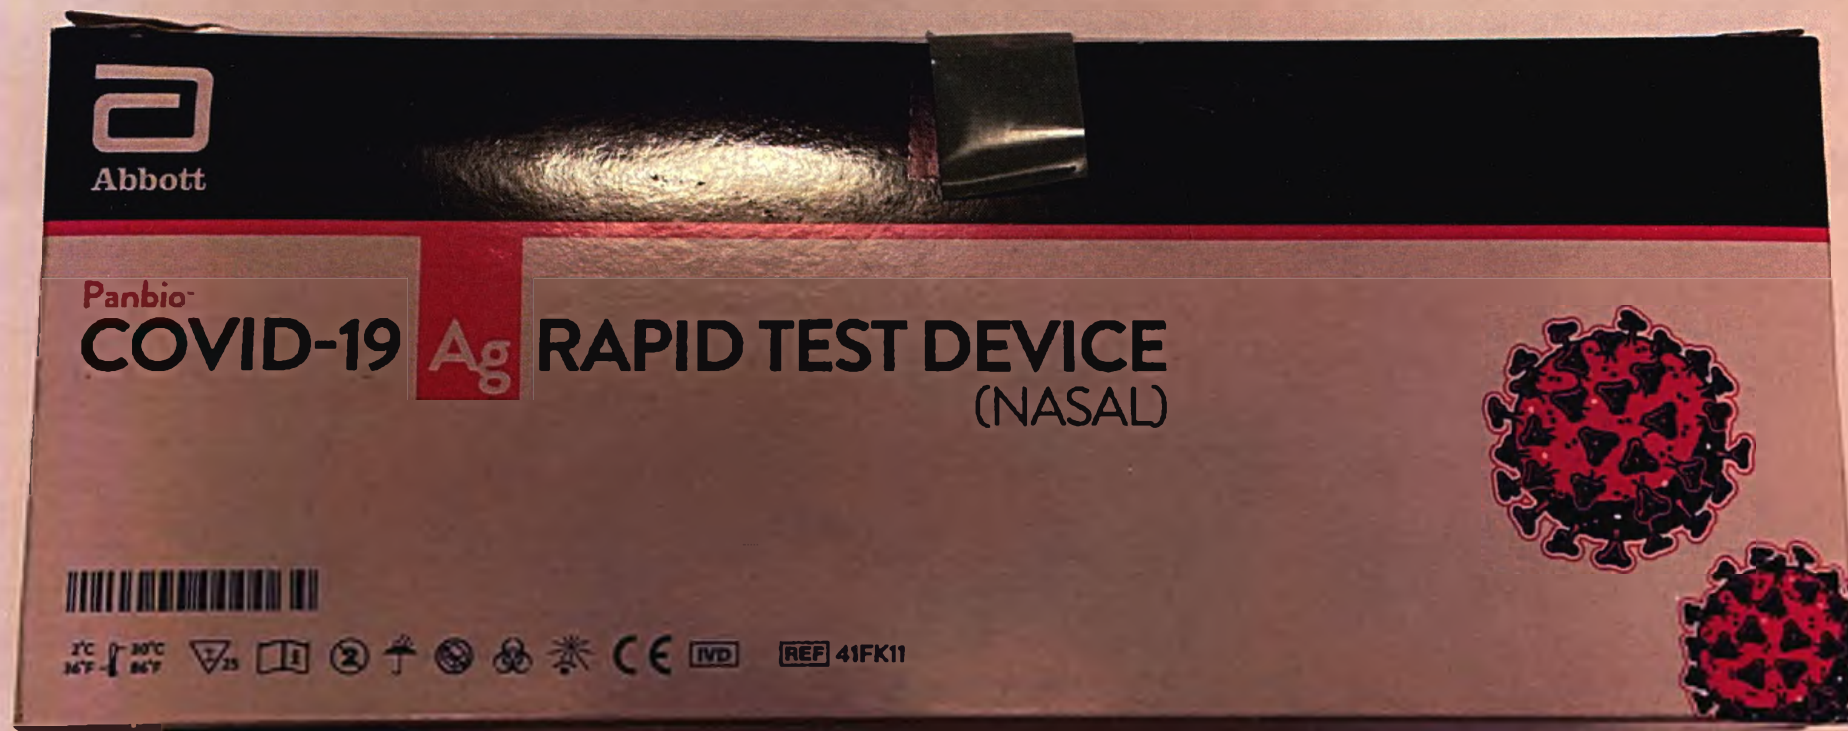



Panbio
COVID-19 Ag
RAPID TEST DEVICE


REF 41FK1-P2



Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poect

2°C 30°C
36°F 86°F



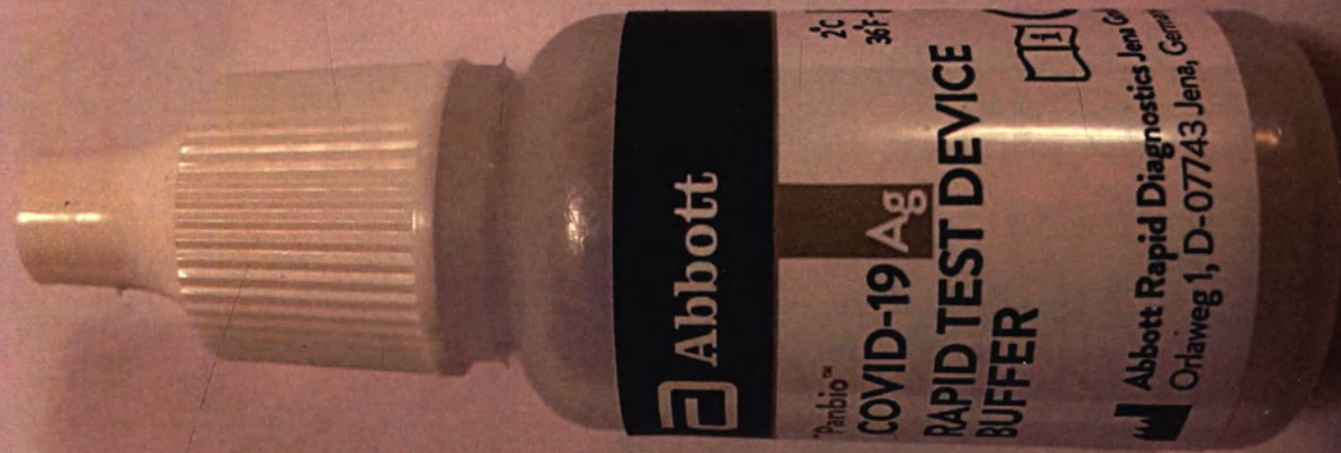


EXTRACTION TUBES

QUANTITY : 25 PCS

CAT. NO. : P78-010/010

LOT NO. : A2011AE



AIM Inc.

101-903, Digital Empire II, Sinwon-ro 88
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, 16681

EXTRACTION TUBE CAPS

QUANTITY : 25 PCS


CAT. NO. : P78-010/010

LOT NO. : A2011AE



AIM Inc.

101-903, Digital Empire-II, Sinwon-ro 88
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea, 16681



Panbio™

COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE

Positive Control

CONTROL +

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

2°C 30°C
36°F 86°F



IVD

REF

41FK1-PC

41F1-PC-FA-A1

LOT NO.:
EXP. DATE:
(YY/MM/DD)

41AW10588F
2023.09.09



CONTROL USE ONLY
DO NOT USE for
specimen collection



Panbio™

COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE

Negative Control

CONTROL -

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

2°C 30°C
36°F 86°F



IVD

REF

41FK1-NC


41F1-NC-FA-A1

LOT NO.:
EXP. DATE:
(YY/MM/DD)

11910F
2023.01.17




CONTROL USE ONLY
DO NOT USE for
specimen collection

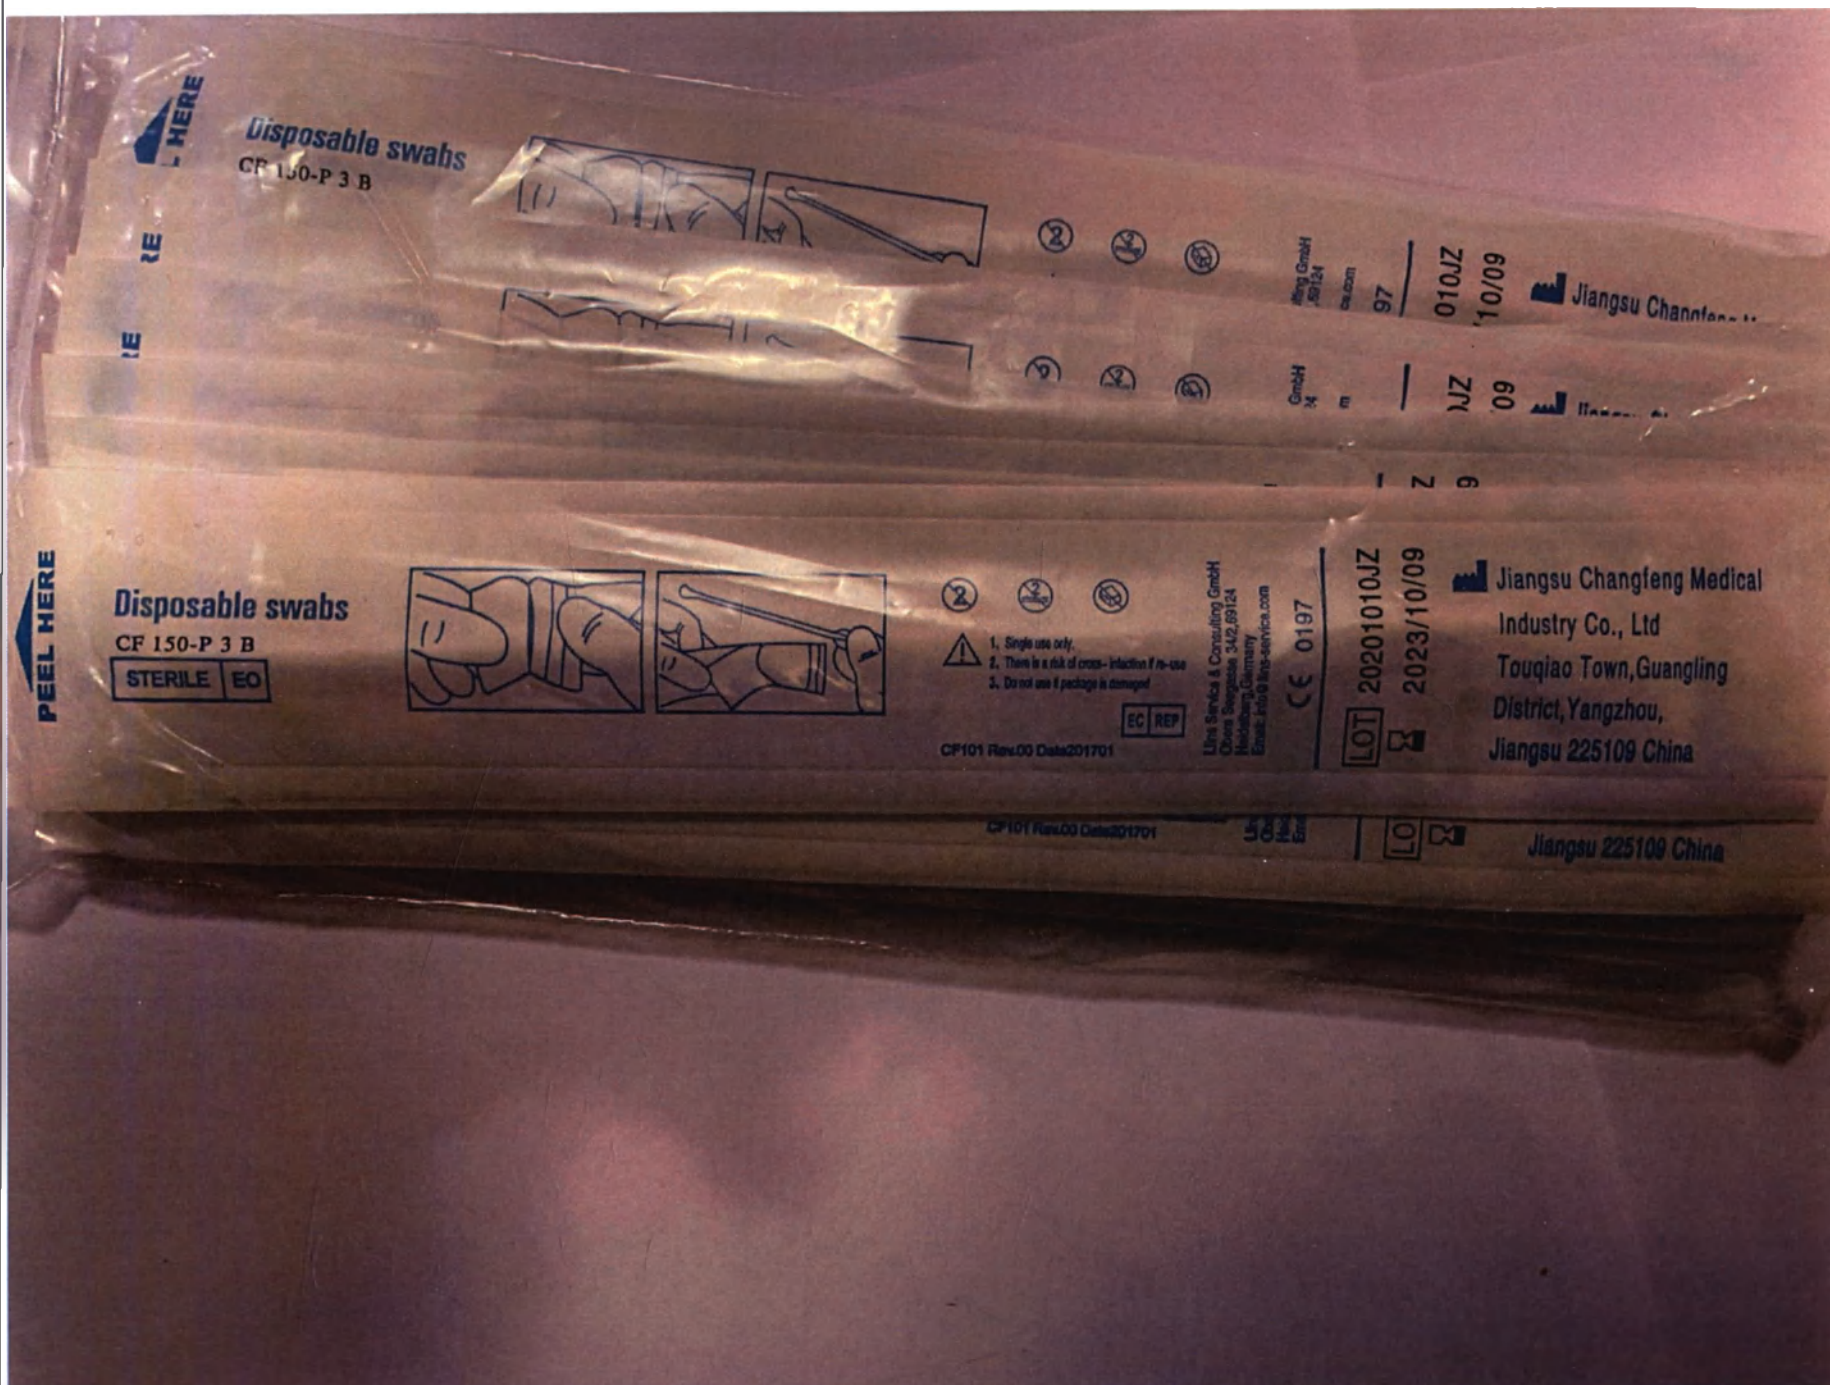


NASAL SWAB


QUANTITY : 25 PCS



NS-RO



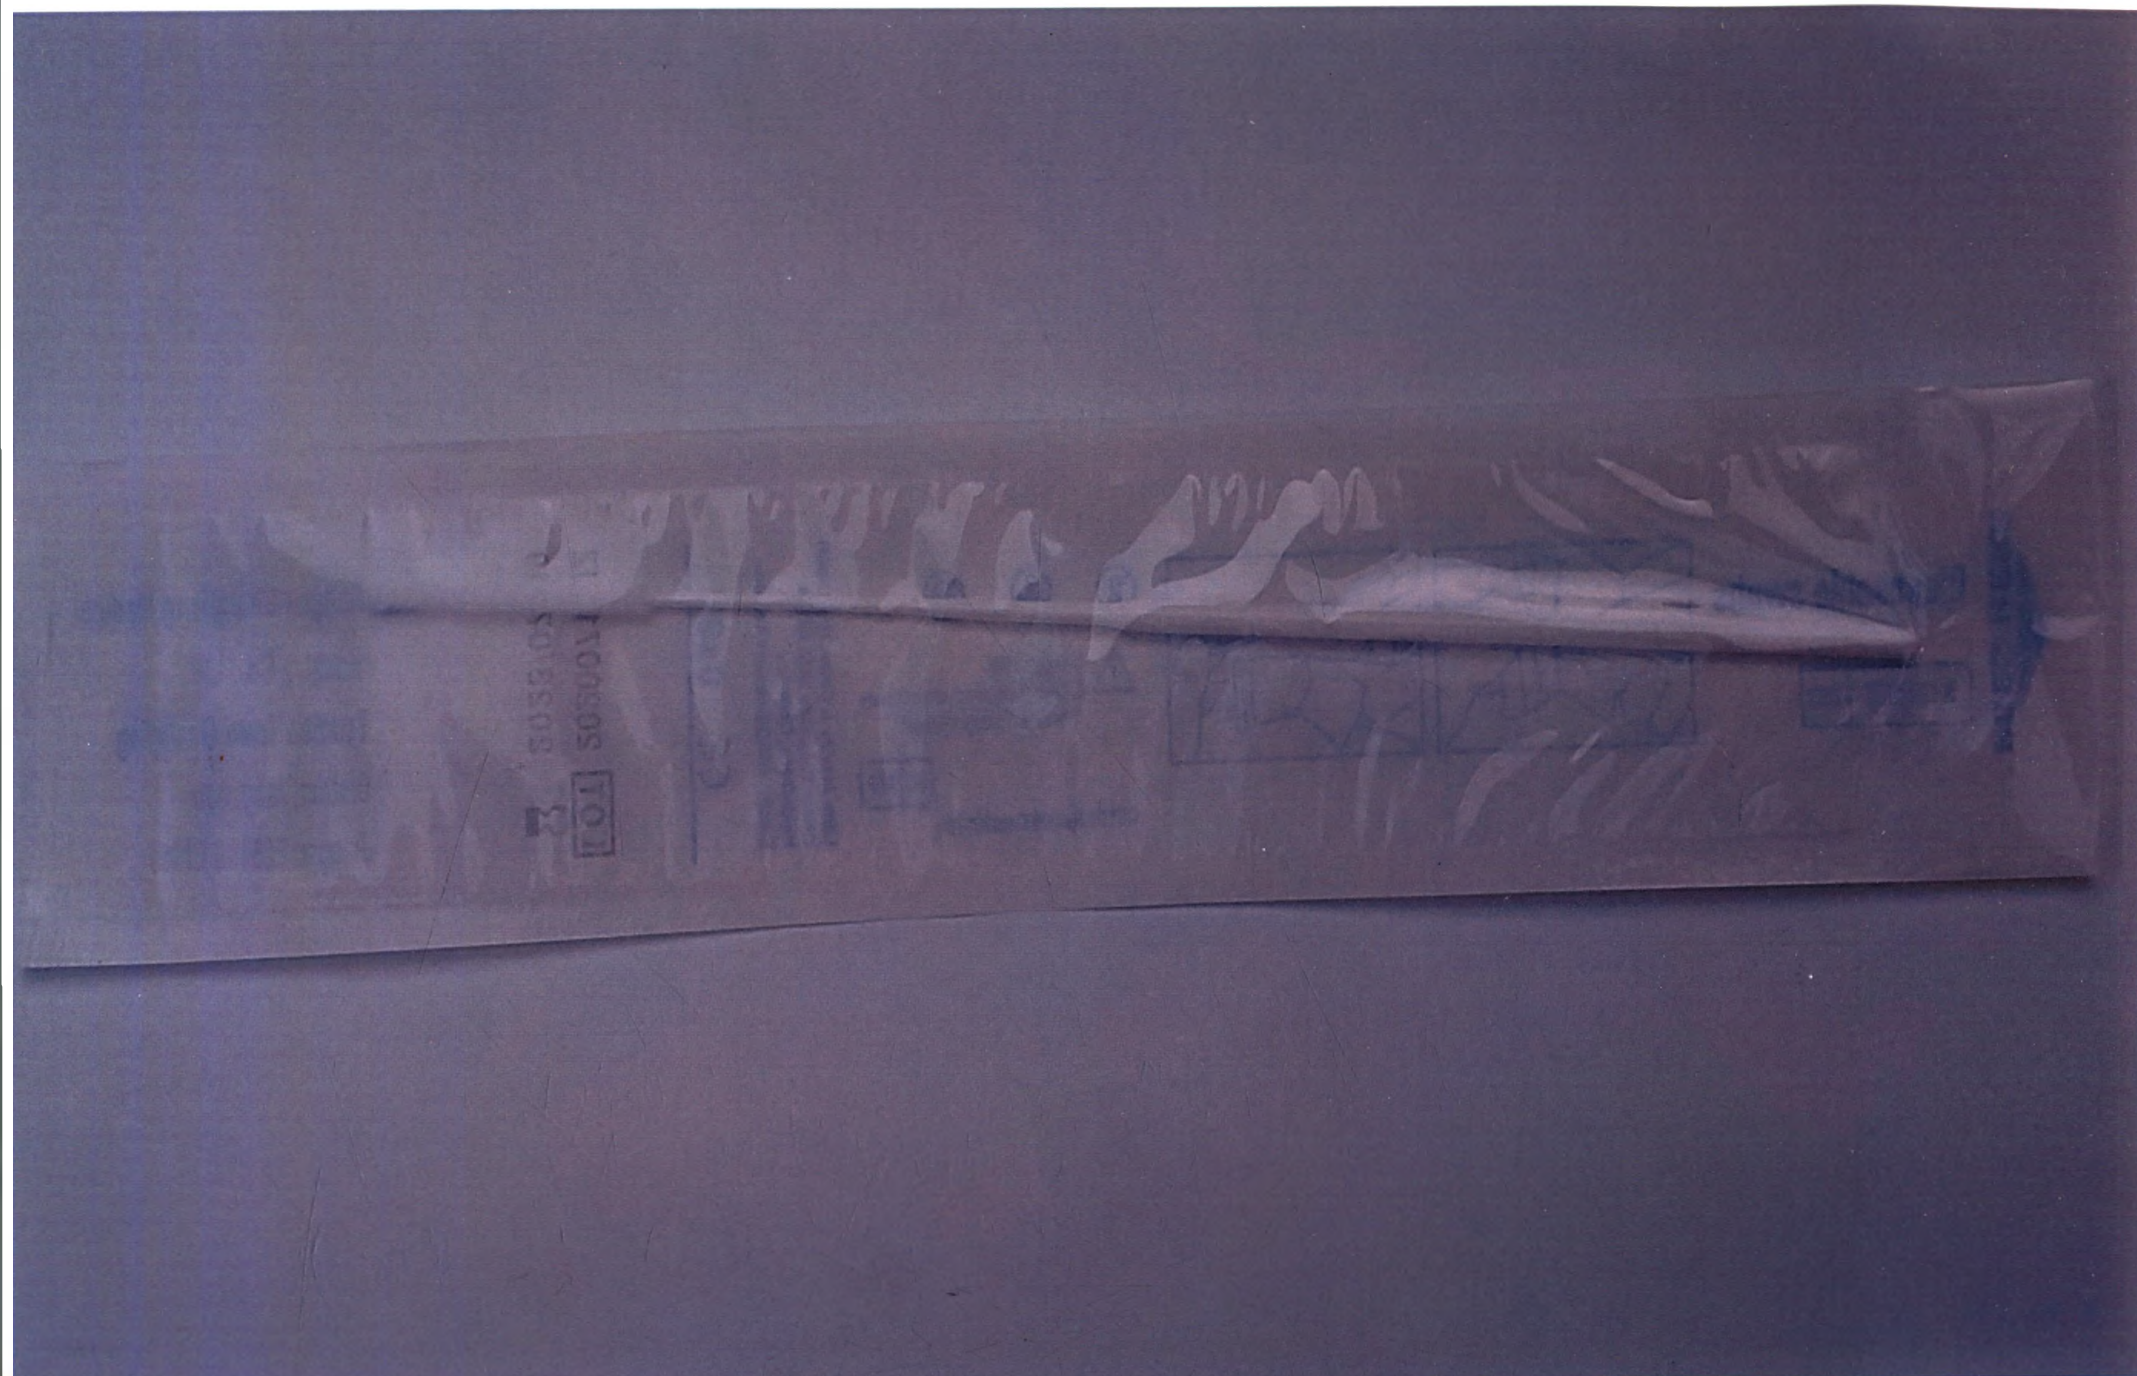

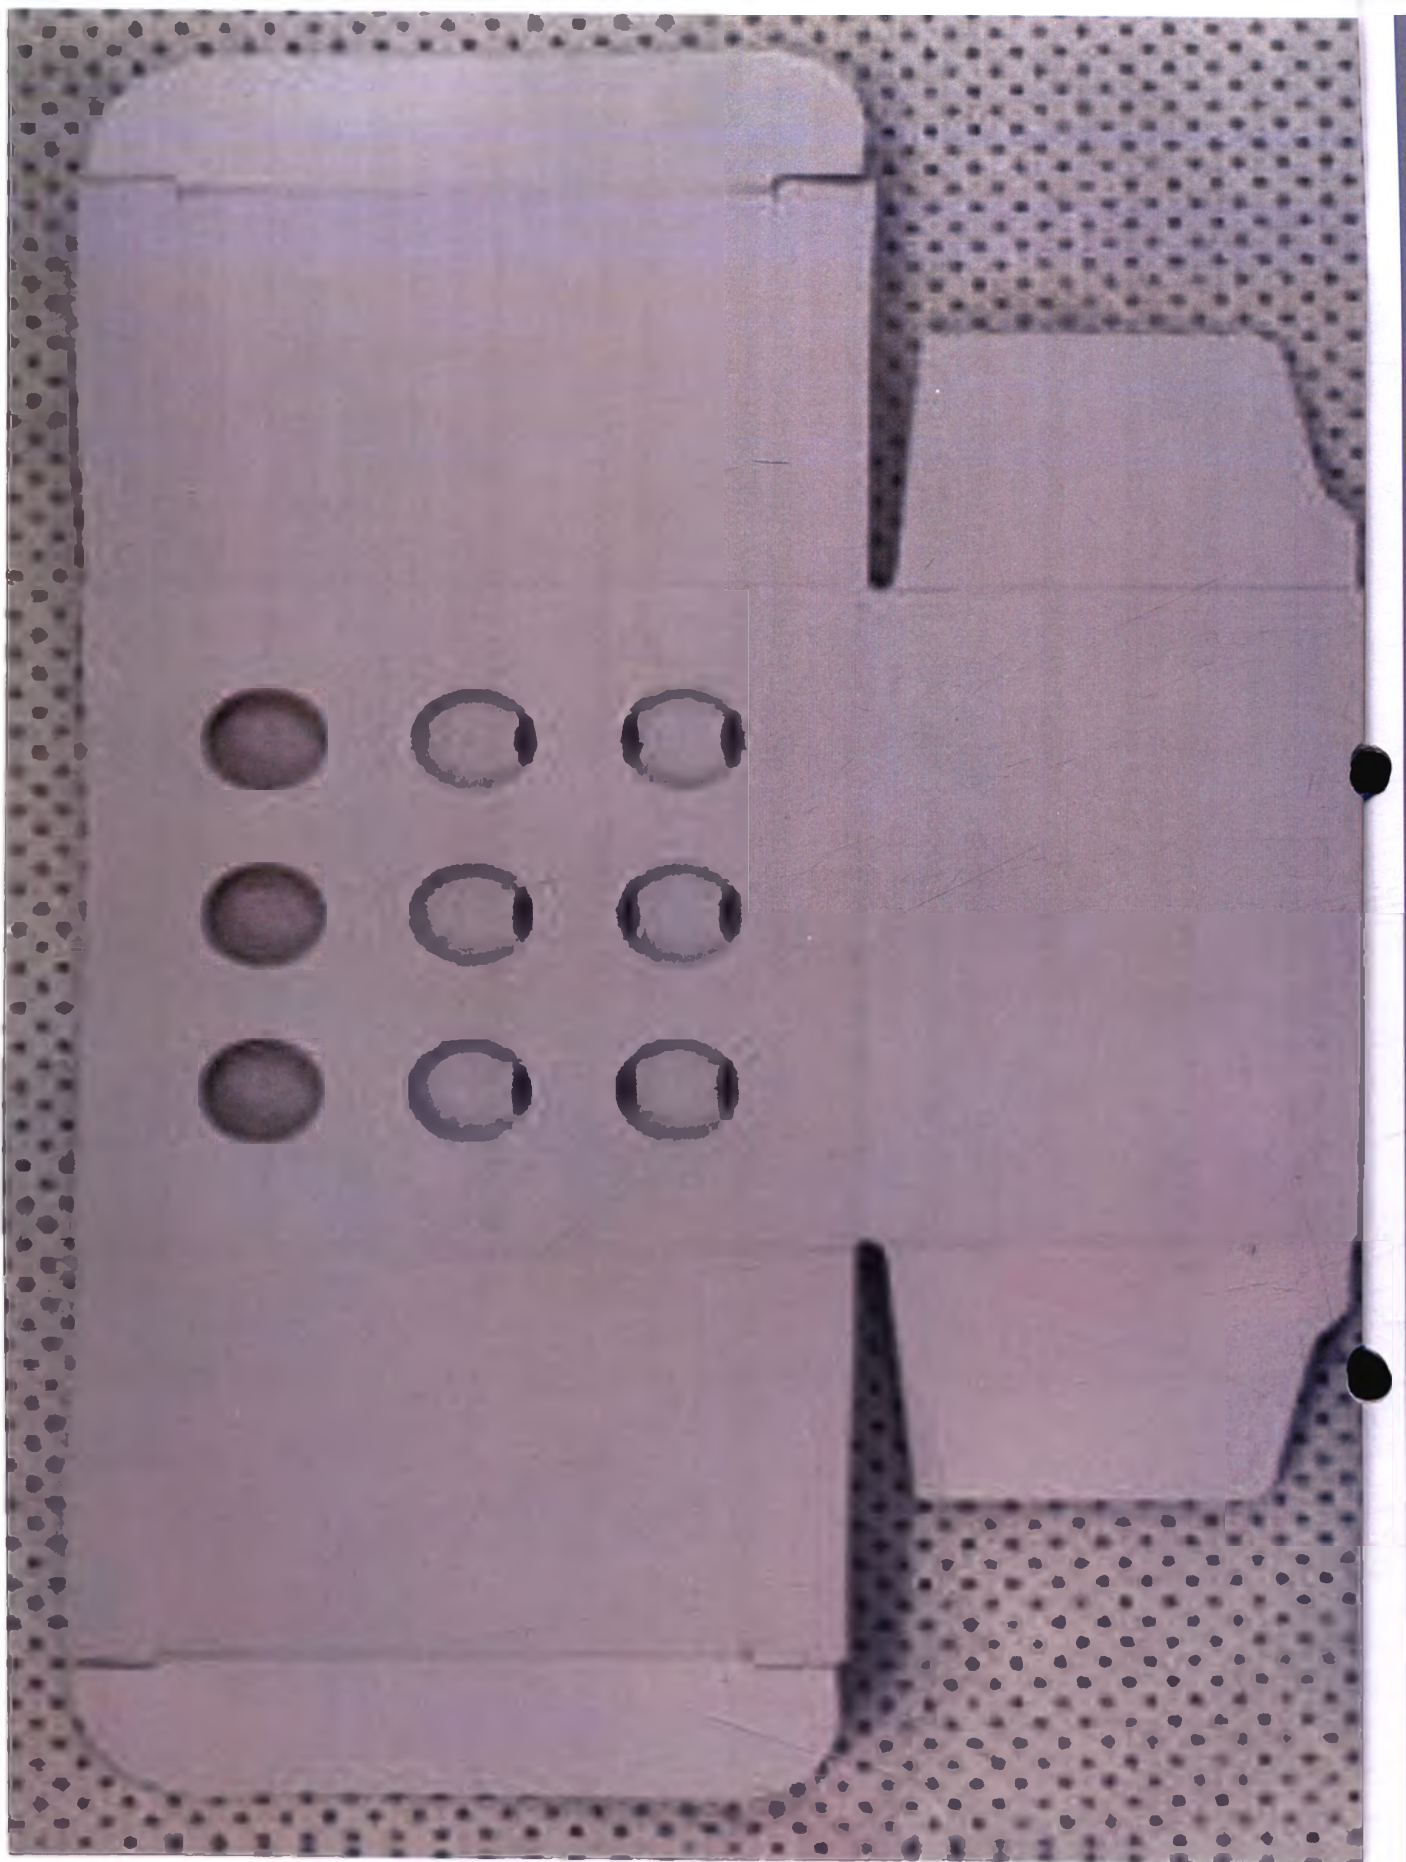

Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа или носоглотки человека иммунохроматографическим методом «Экспресс-тест Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)»

Вариант исполнения:

1. Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки человека иммунохроматографическим методом «Экспресс-тест Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)»

в составе:

1. Тест-кассеты в индивидуальной вакуумной упаковке с осушителем – 25 шт.
2. Буфер - 1 флакон (9 мл./фл.)
3. Пробирки экстракционные – 25 шт.
4. Колпачки для пробирок экстракционных – 25 шт.
5. Положительный контрольный образец – 1 шт.
6. Отрицательный контрольный образец – 1 шт.
7. Стерильные назофарингеальные тампоны (тупферы) для сбора образцов – 25 шт.
8. Штатив – 1 шт.
9. Краткое руководство (назофарингеальный тампон) – 1 шт.
10. Инструкция по применению – 1 шт.



Эбботт Рэпид Диагностикас Йена ГмбХ, Германия

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH, Orlaweg 1, 07743 Jena, Germany

Телефон: +49 (0) 3641 3111-0

Эл.адрес: ati.info@abbott.com

Место производства: Эбботт Диагностикас Корея Инк. (Abbott Diagnostics Korea Inc.) 65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17099, Republic of Korea

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15265 от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, Д. 16 А. Стр 1

Тел 7 (495) 258-42-80

Для профессионального применения

Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа или носоглотки человека иммунохроматографическим методом «Экспресс-тест Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)»

Вариант исполнения:

Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа человека иммунохроматографическим методом «Экспресс-тест Panbio™ COVID-19 Ag (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)»

в составе:

1. Тест-кассеты в индивидуальной вакуумной упаковке с осушителем – 25 шт.
2. Буфер - 1 флакон (9 мл./фл.)
3. Пробирки экстракционные – 25 шт.
4. Колпачки для пробирок экстракционных – 25 шт.
5. Положительный контрольный образец – 1 шт.
6. Отрицательный контрольный образец – 1 шт.
7. Стерильные назальные тампоны (тупферы) для сбора образцов – 25 шт.
8. Штатив – 1 шт.
9. Краткое руководство (назальный тампон) – 1 шт.
10. Инструкция по применению – 1 шт.



Эбботт Рэпид Диагностикас Йена ГмбХ (Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH)

Orlaweg 1, 07743 Jena, Germany

Телефон: +49 (0) 3641 3111-0

Эл. адрес: atj.info@abbott.com

Место производства: Эбботт Диагностикас Корея Инк. (Abbott Diagnostics Korea Inc.) 65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17099, Republic of Korea

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15265 от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, Д. 16 А. Стр 1

Тел 7 (495) 258-42-80

Для профессионального применения



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Общество с ограниченной ответственностью
«Эбботт Лабораториз»
_____ Шихова Т.Ю.

