


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
миоглобина STAT иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Миоглобин STAT
Калибраторы (Alinity i STAT Myoglobin Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



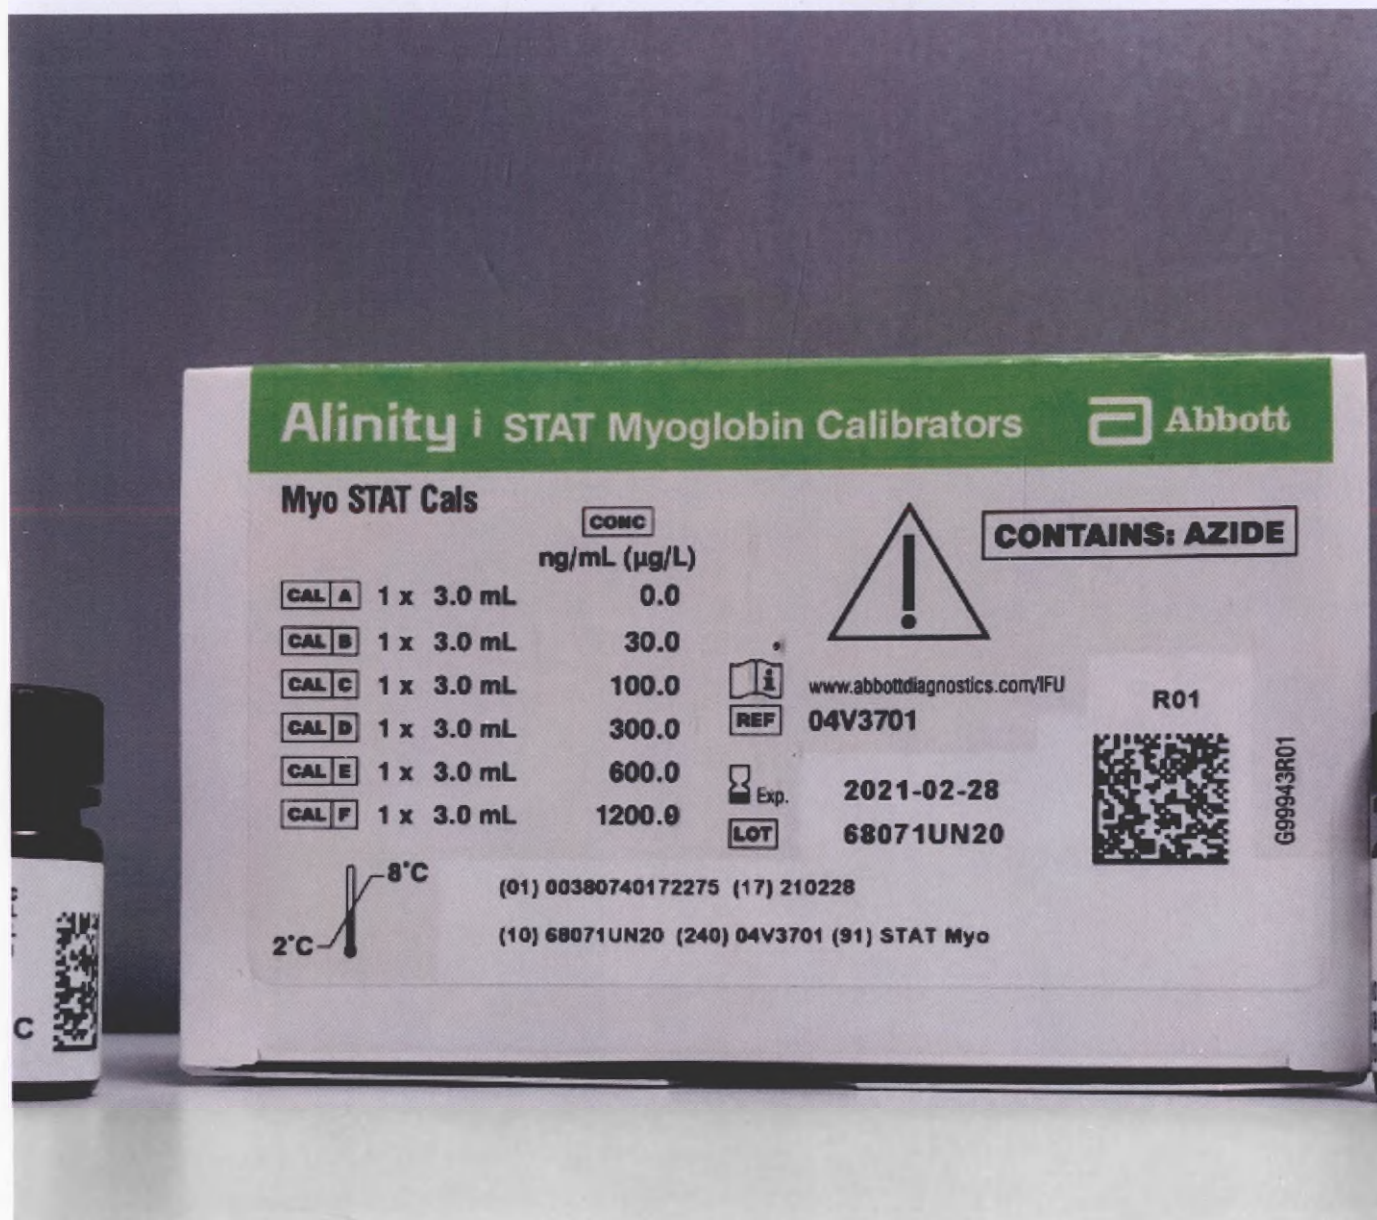

Фотографическое изображение флаконов Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i STAT Myoglobin Calibrators)

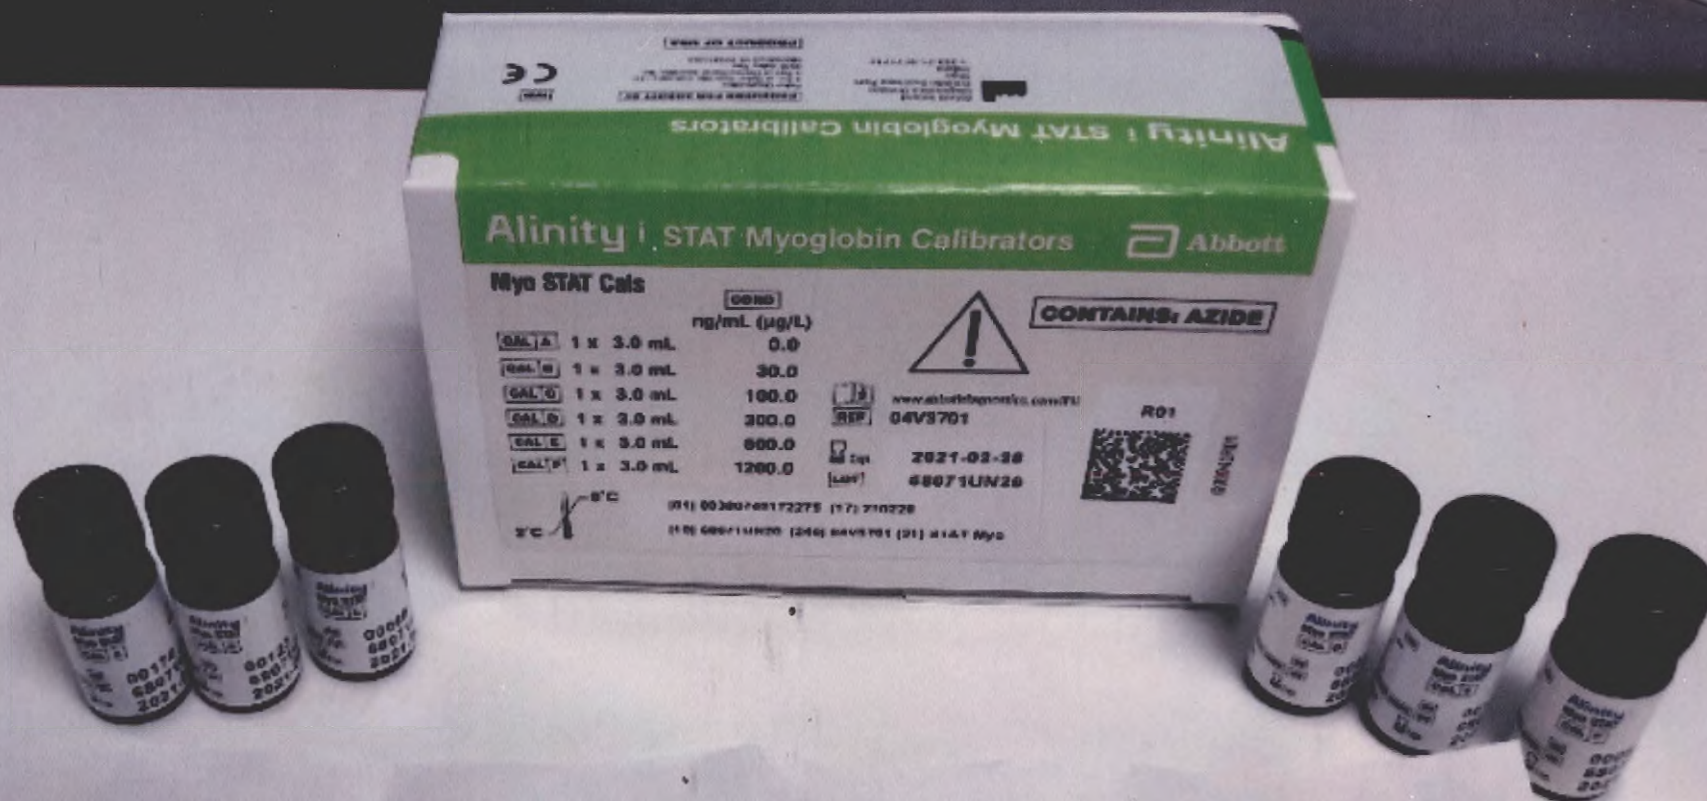

Alinity i
STAT Myoglobin Calibrators

en
Myo STAT
REF 04V3701
G99932R01
S4V370

всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

листов

Подпись _____




Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения миоглобина
STAT иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i STAT
Myoglobin Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i STAT Myoglobin Calibrators), Кат. №04V37301



04V3701



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения миоглобина STAT иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «**Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i STAT Myoglobin Calibrators)**»

в составе: Калибратор А (Alinity i Myo STAT CAL A) -1 флакон х 3,0 мл; Калибратор В (Alinity i Myo STAT CAL B) -1 флакон х 3,0 мл; Калибратор С (Alinity i Myo STAT CAL C) -1 флакон х 3,0 мл; Калибратор D (Alinity i Myo STAT CAL D) -1 флакон х 3,0 мл; Калибратор Е (Alinity i Myo STAT CAL E) -1 флакон х 3,0 мл; Калибратор F (Alinity i Myo STAT CAL F) -1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Fisher Diagnostics, A division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike Middletown, VA 22645, USA / Страна происхождения: США / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия,

г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,•

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i
STAT Myoglobin Calibrators), Кат. №04V37301

Myo STAT Cals



PRODUCT OF USA
Abbott Molecular Inc.
A Division of Abbott Laboratories
Abbott Park, Abbott Park, IL 60014-3000, USA
Abbott Molecular Inc.
A Division of Abbott Laboratories
Abbott Park, Abbott Park, IL 60014-3000, USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Fincham Business Park
Silloo
Ireland
+353-71-9171712

Abbott

Alinity i STAT Myoglobin Calibrators

Alinity i STAT Myoglobin Calibrators Abbott

Myo STAT Cals

		CONC
		ng/mL (µg/L)
CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	30.0
CAL C	1 x 3.0 mL	100.0
CAL D	1 x 3.0 mL	300.0
CAL E	1 x 3.0 mL	600.0
CAL F	1 x 3.0 mL	1200.0



CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF


04V3701



Exp.


LOT

G999 43R01




Макет маркировки компонентов медицинского изделия Миоглобин STAT Калибраторы (Alinity i
STAT Myoglobin Calibrators), Кат. №04V37301


- Калибратор А (Alinity i Myo STAT CAL A)

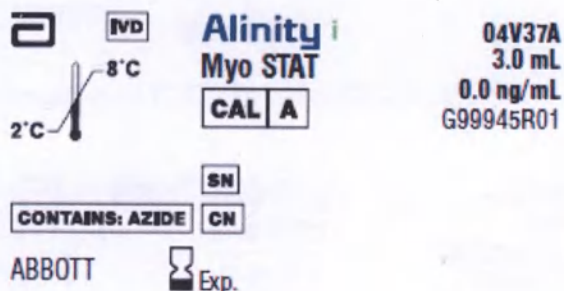

- Калибратор В (Alinity i Myo STAT CAL B)

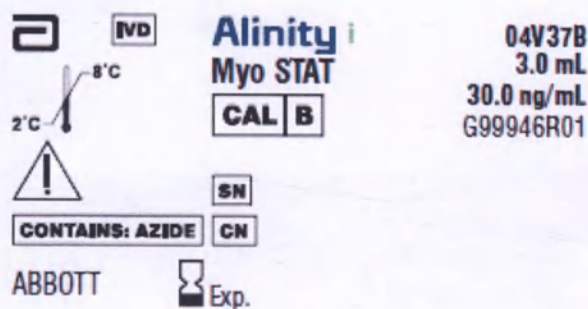

- Калибратор С (Alinity i Myo STAT CAL C)

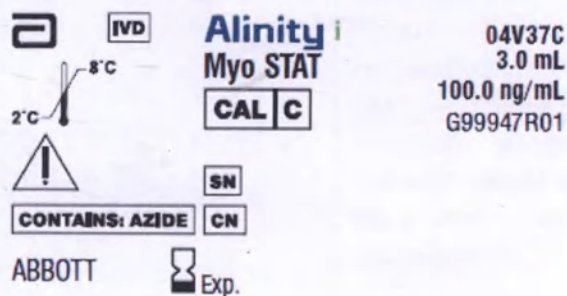

- Калибратор D (Alinity i Myo STAT CAL D)



• Калибратор E (Alinity i Myo STAT CAL E)



• Калибратор F (Alinity i Myo STAT CAL F)



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано _____

и скреплено печатью _____

листов _____

Подпись _____

