


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО НМФ «МБН»

 Шалыгин В.С.

«23» ноября 2017 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплекс многофункциональный компьютеризированный
для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор» по ТУ
9441-023-42882497-2009**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Медицинская Фирма МБН» (ООО НМФ «МБН»)

Адрес места производства: Россия, 115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, стр. 7

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07889 от
27.05.2010 г.**

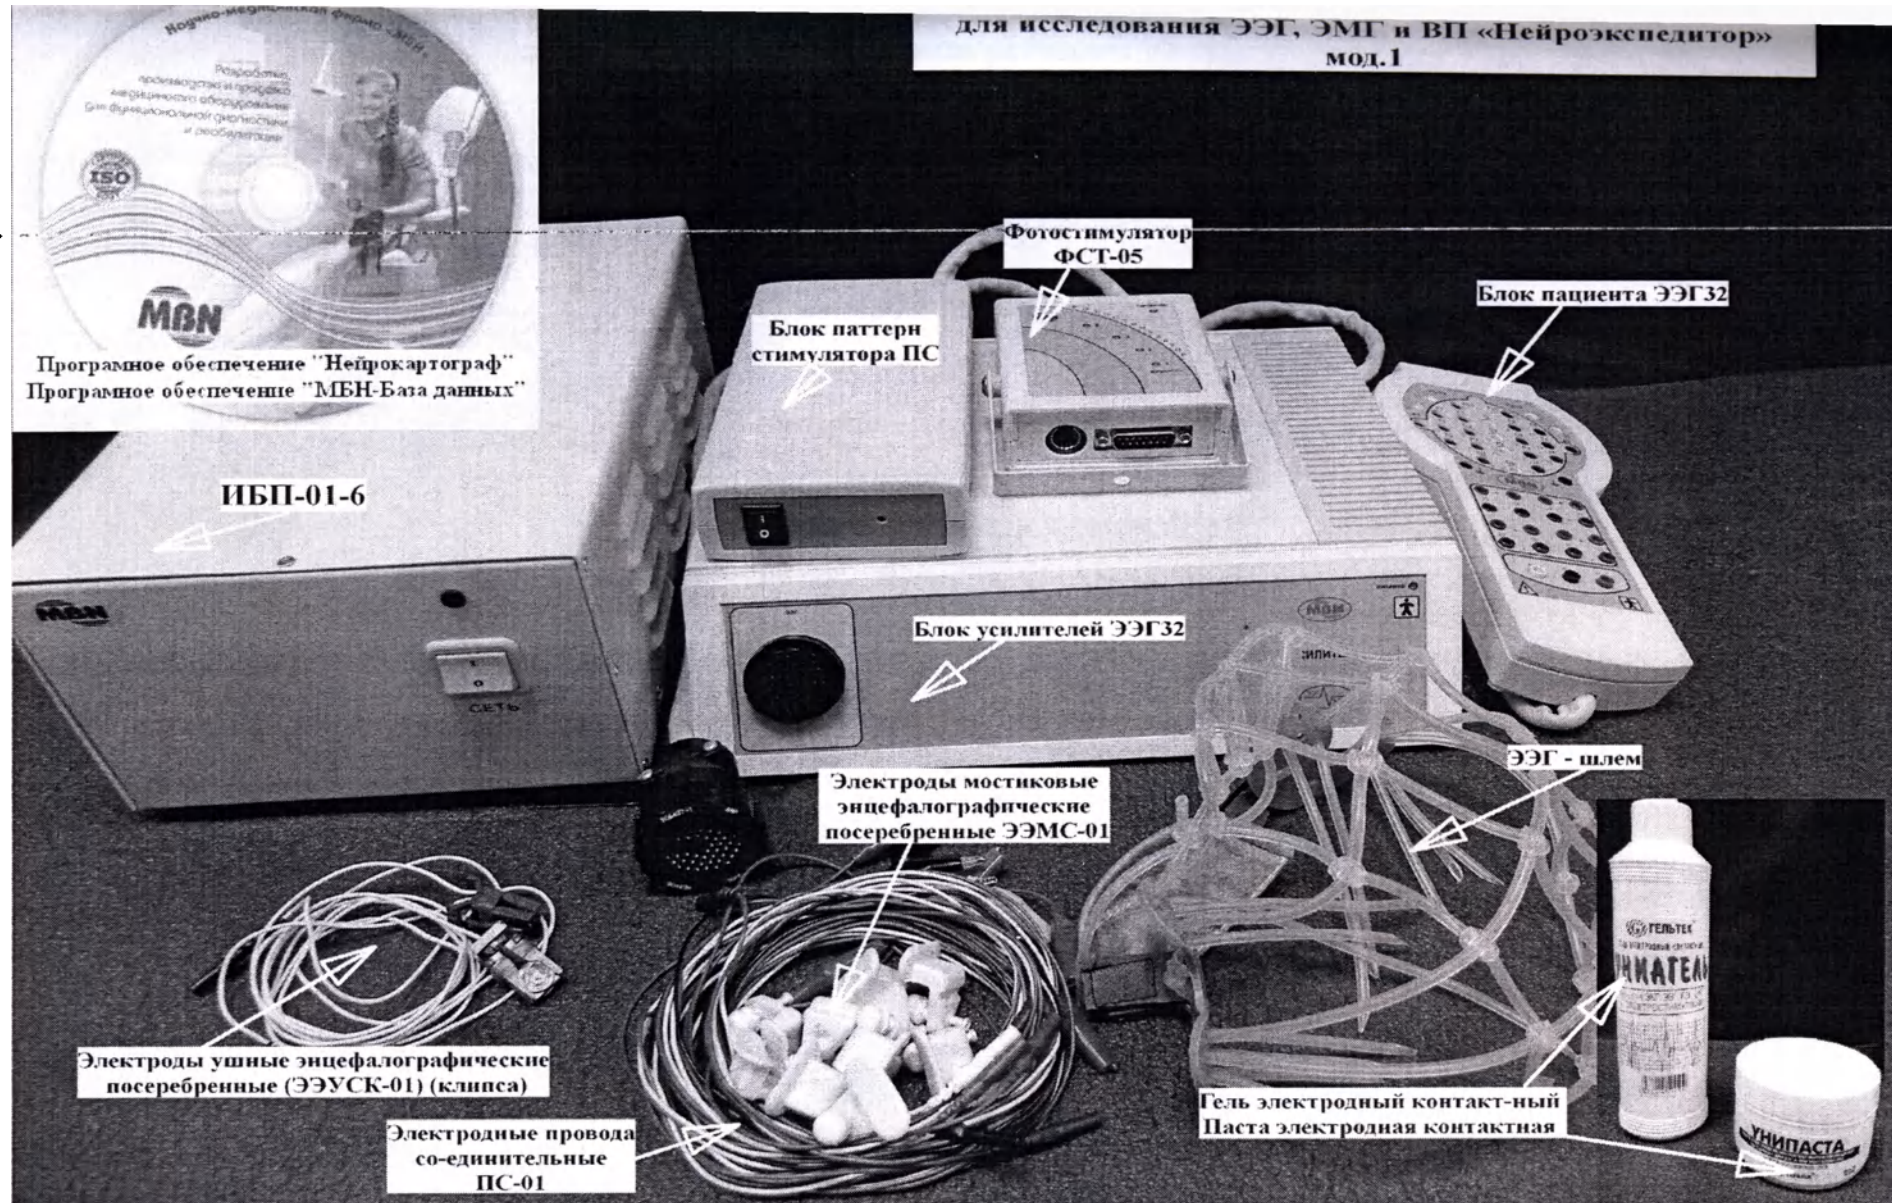


Рис. 1 – Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор»
по ТУ 9441-023-42882497-2009 (мод.1)

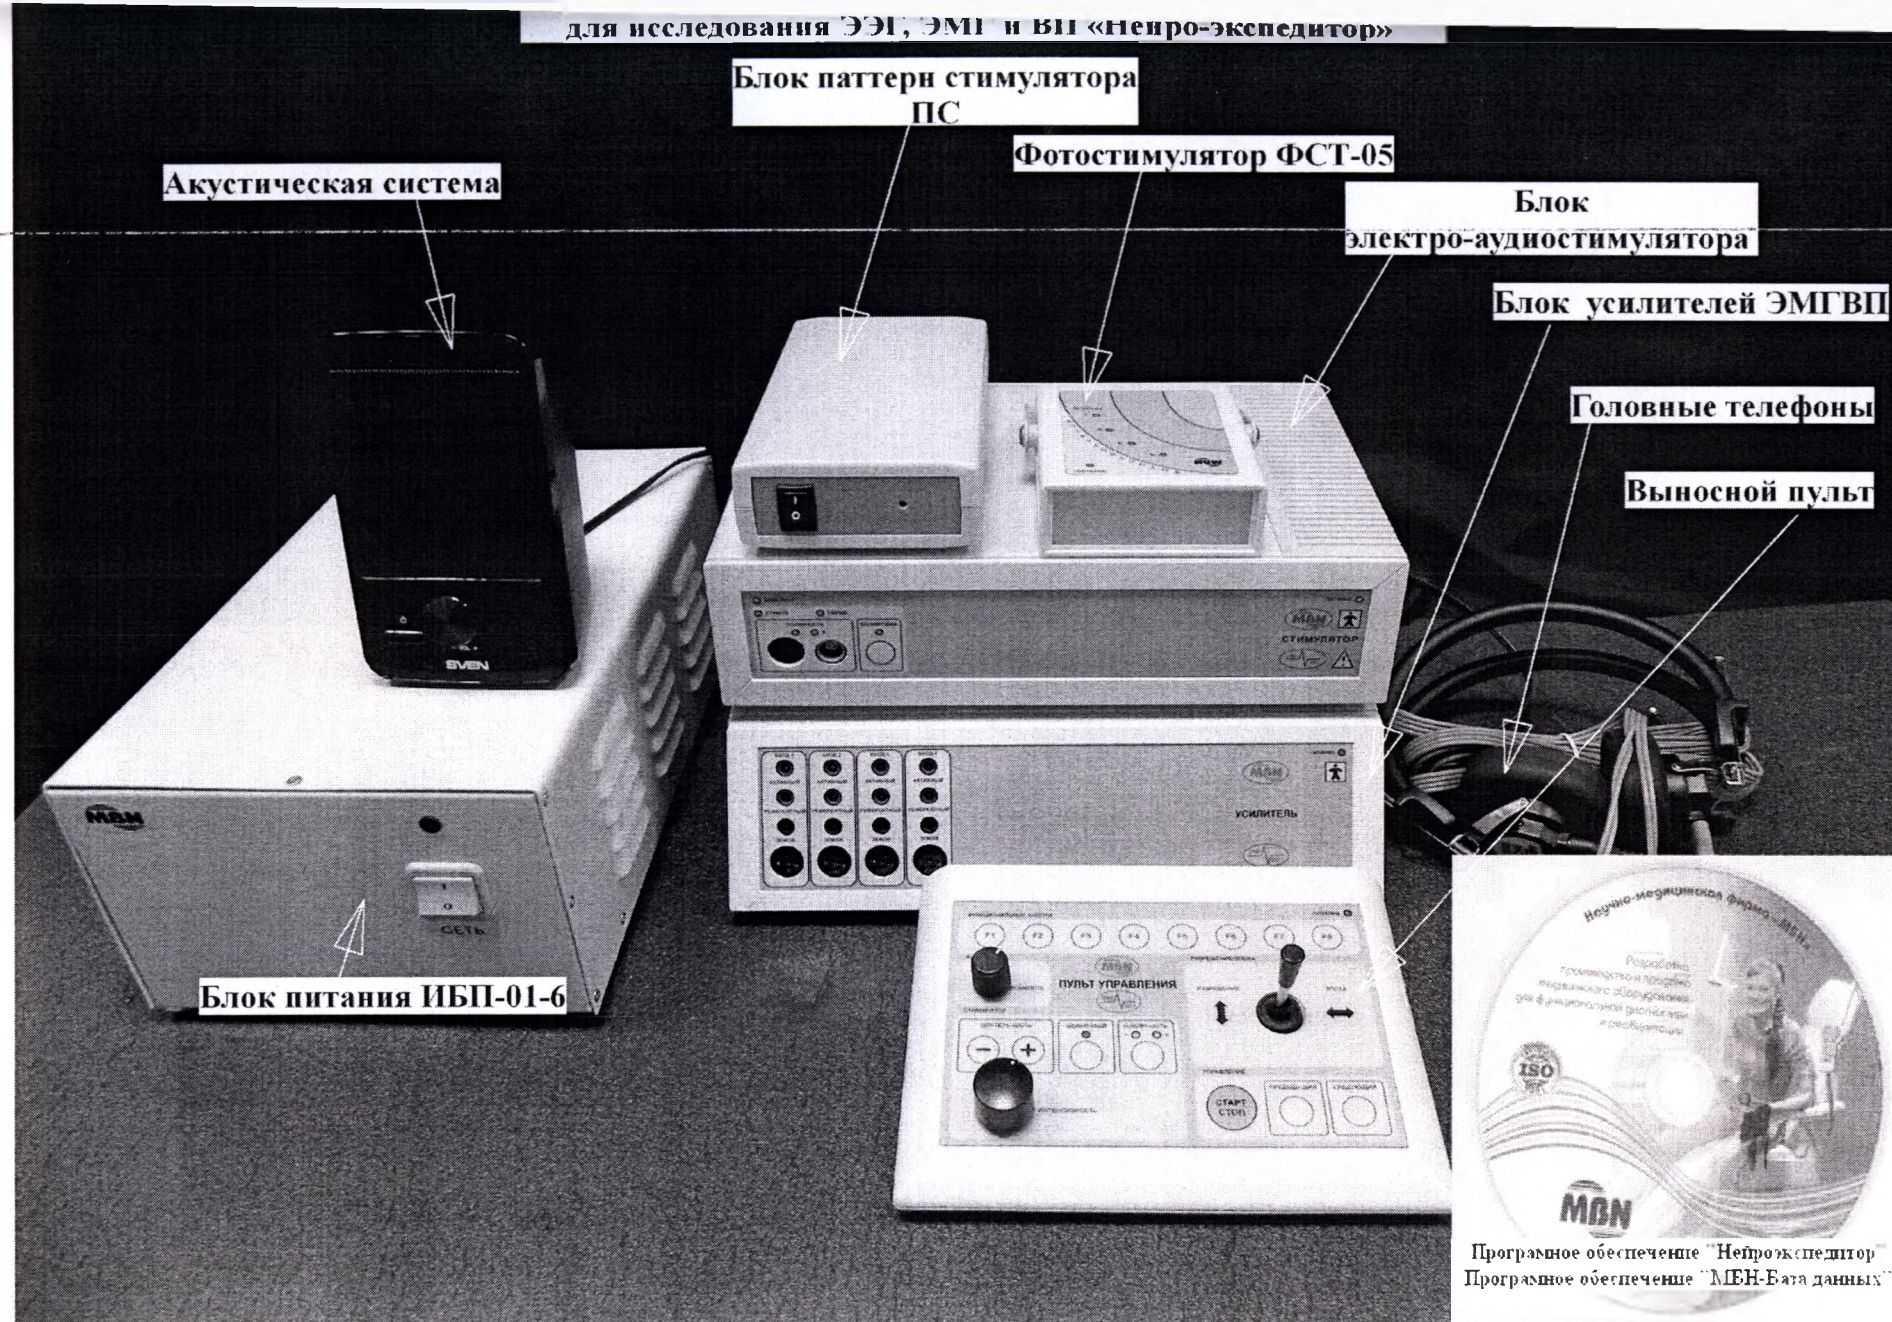


Рис. 2 – Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор»

по ТУ 9441-023-42882497-2009 (мод. 2)

для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор»
 мод.2 Electrodes

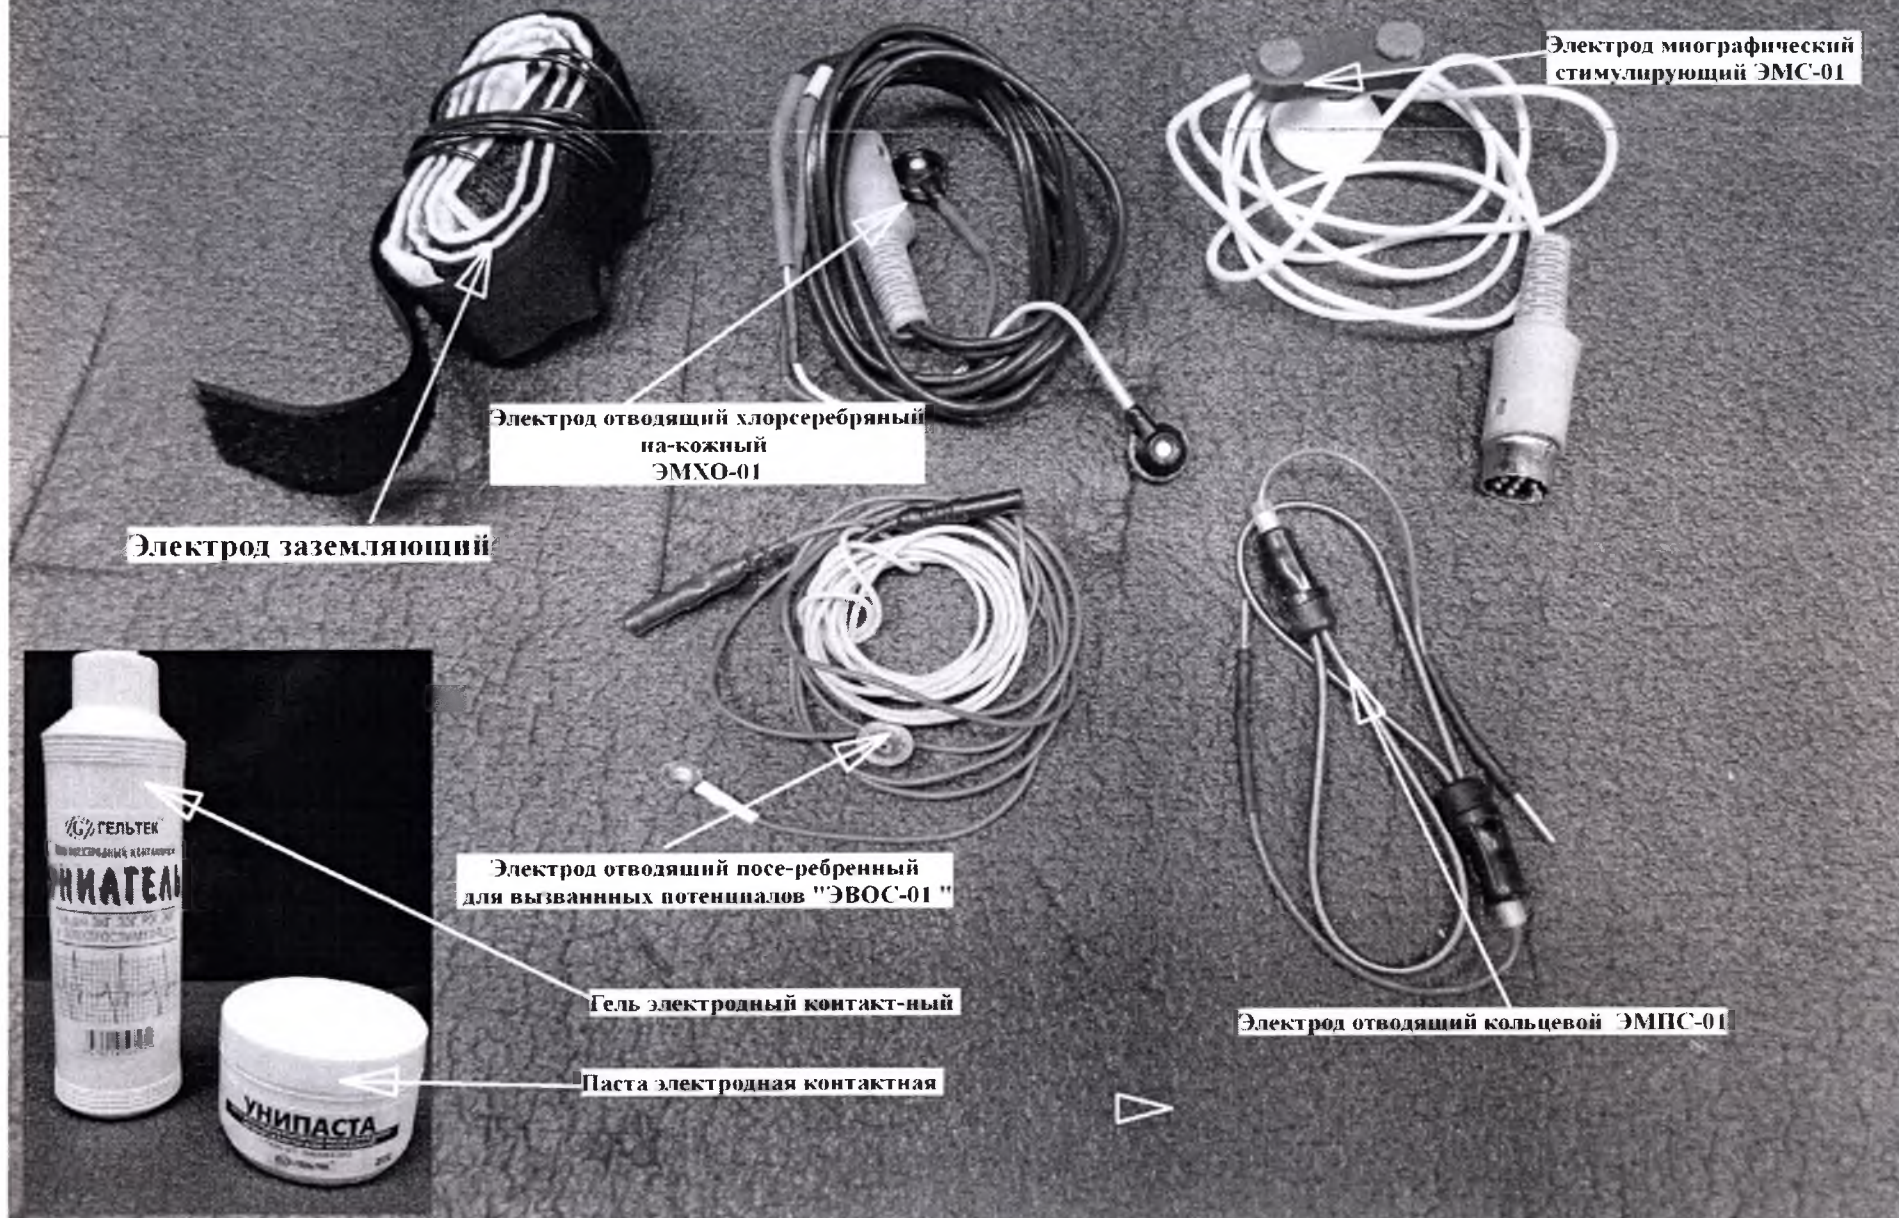


Рис. 3 – Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор»

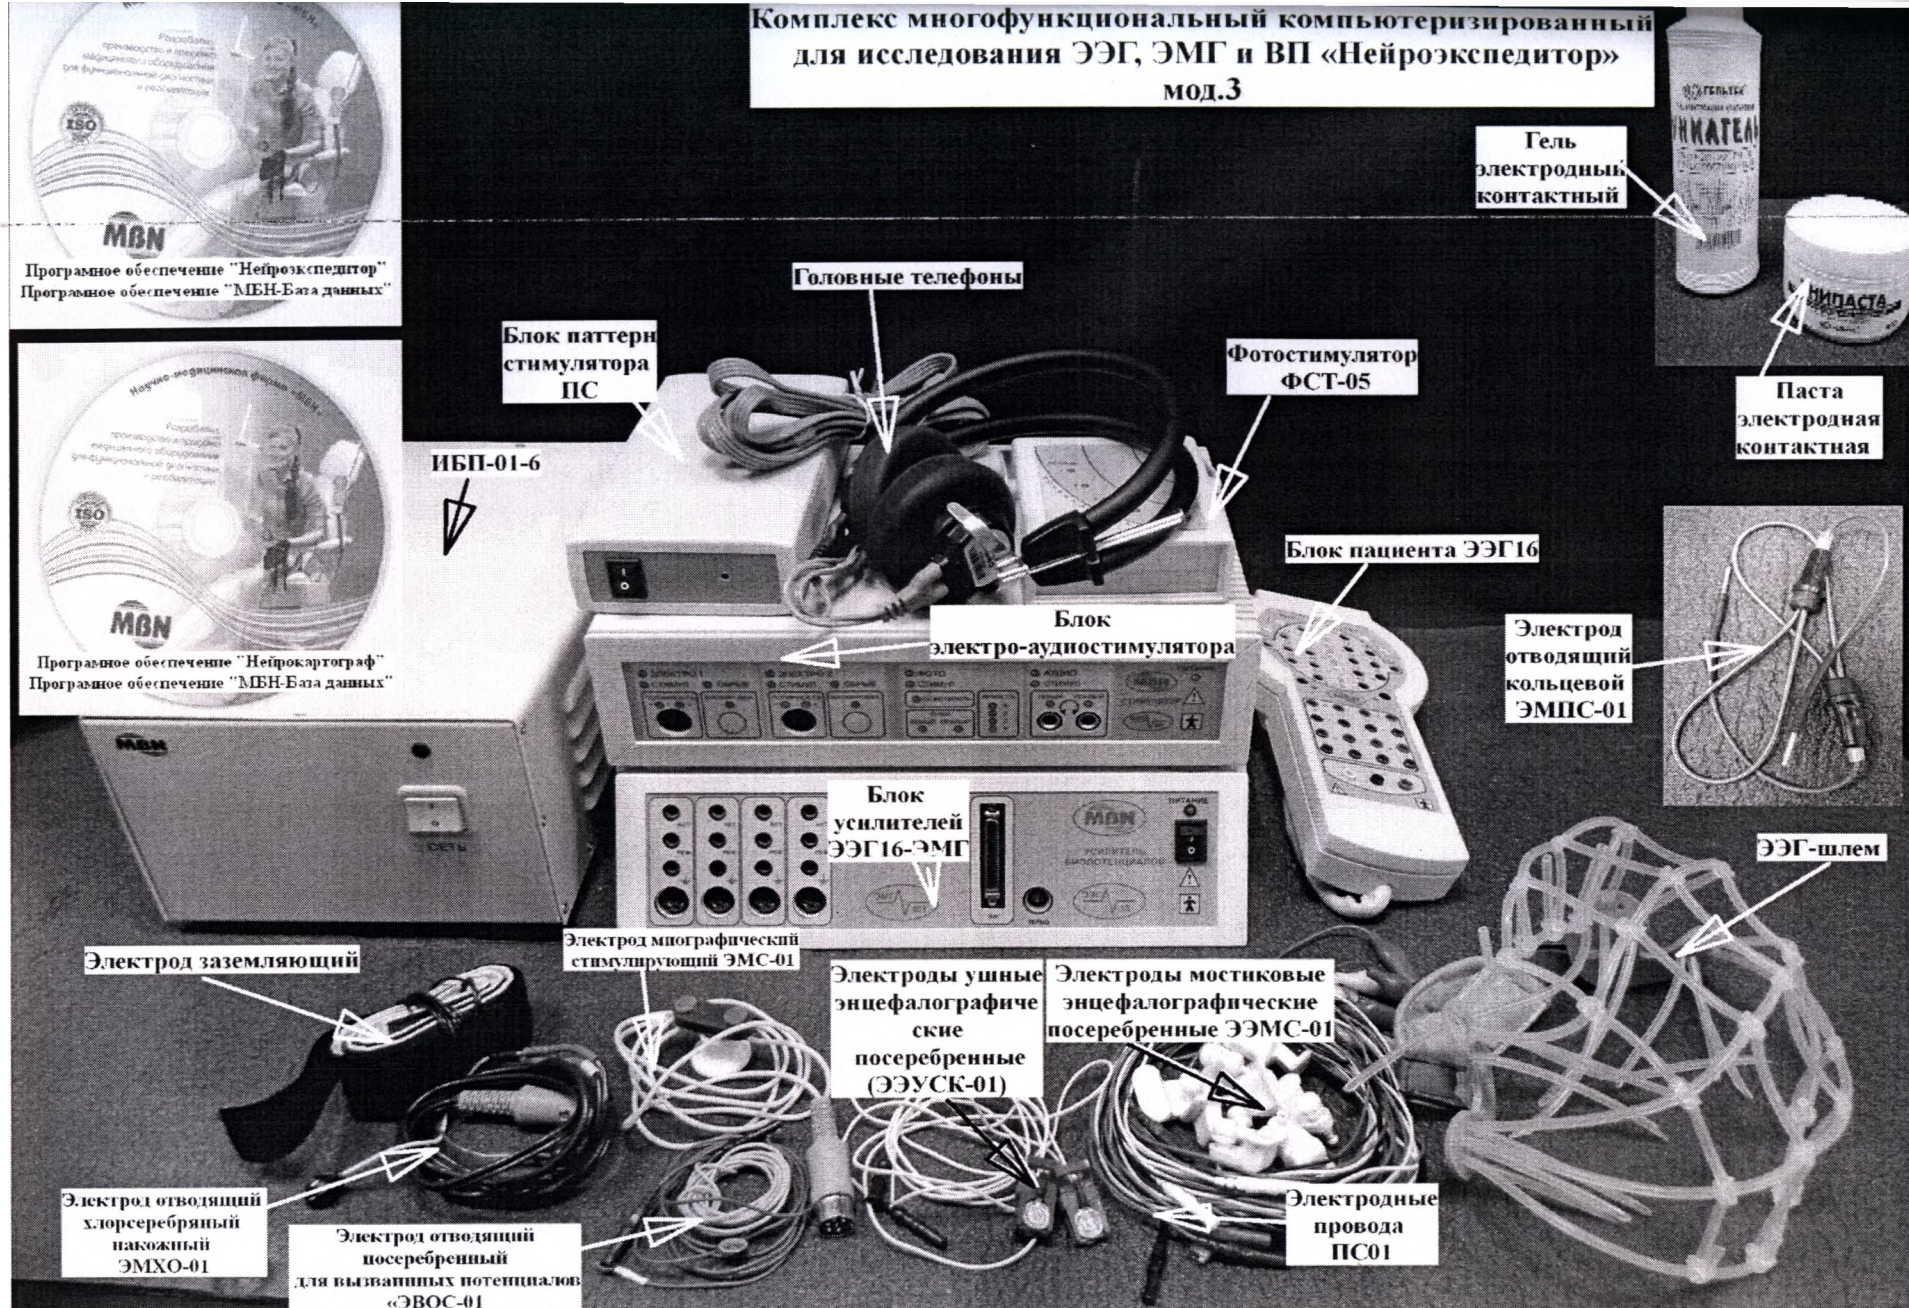


Рис. 4 – Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор»



Комплекс многофункциональный
компьютеризированный для
исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП
«НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»
РУ № ФСР 2010/07889

Блок стимуляторов

зав. № _____
по ТУ 9441-023-42882497-2009
год изготовления _____

Упит.1 = +15 В; I1 = 1 А

Упит.2 = -15 В; I2 = 1 А

Упит.3 = +9 В; I3 = 0,6 А



Комплекс многофункциональный
компьютеризированный для
исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП
«НЕЙРОЭКСПЕДИТОР»
РУ № ФСР 2010/07889

Блок усилителя

зав. № _____
по ТУ 9441-023-42882497-2009
год изготовления _____

Упит.1 = +15 В; I1 = 1 А

Упит.2 = -15 В; I2 = 1 А

Упит.3 = +9 В; I3 = 1,2 А

Упит.4 = +15 В; I4 = 1 А

Упит.5 = -15 В; I5 = 1 А



Фото 5 – Маркировка медицинского изделия: Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор» по ТУ 9441-023-42882497-2009

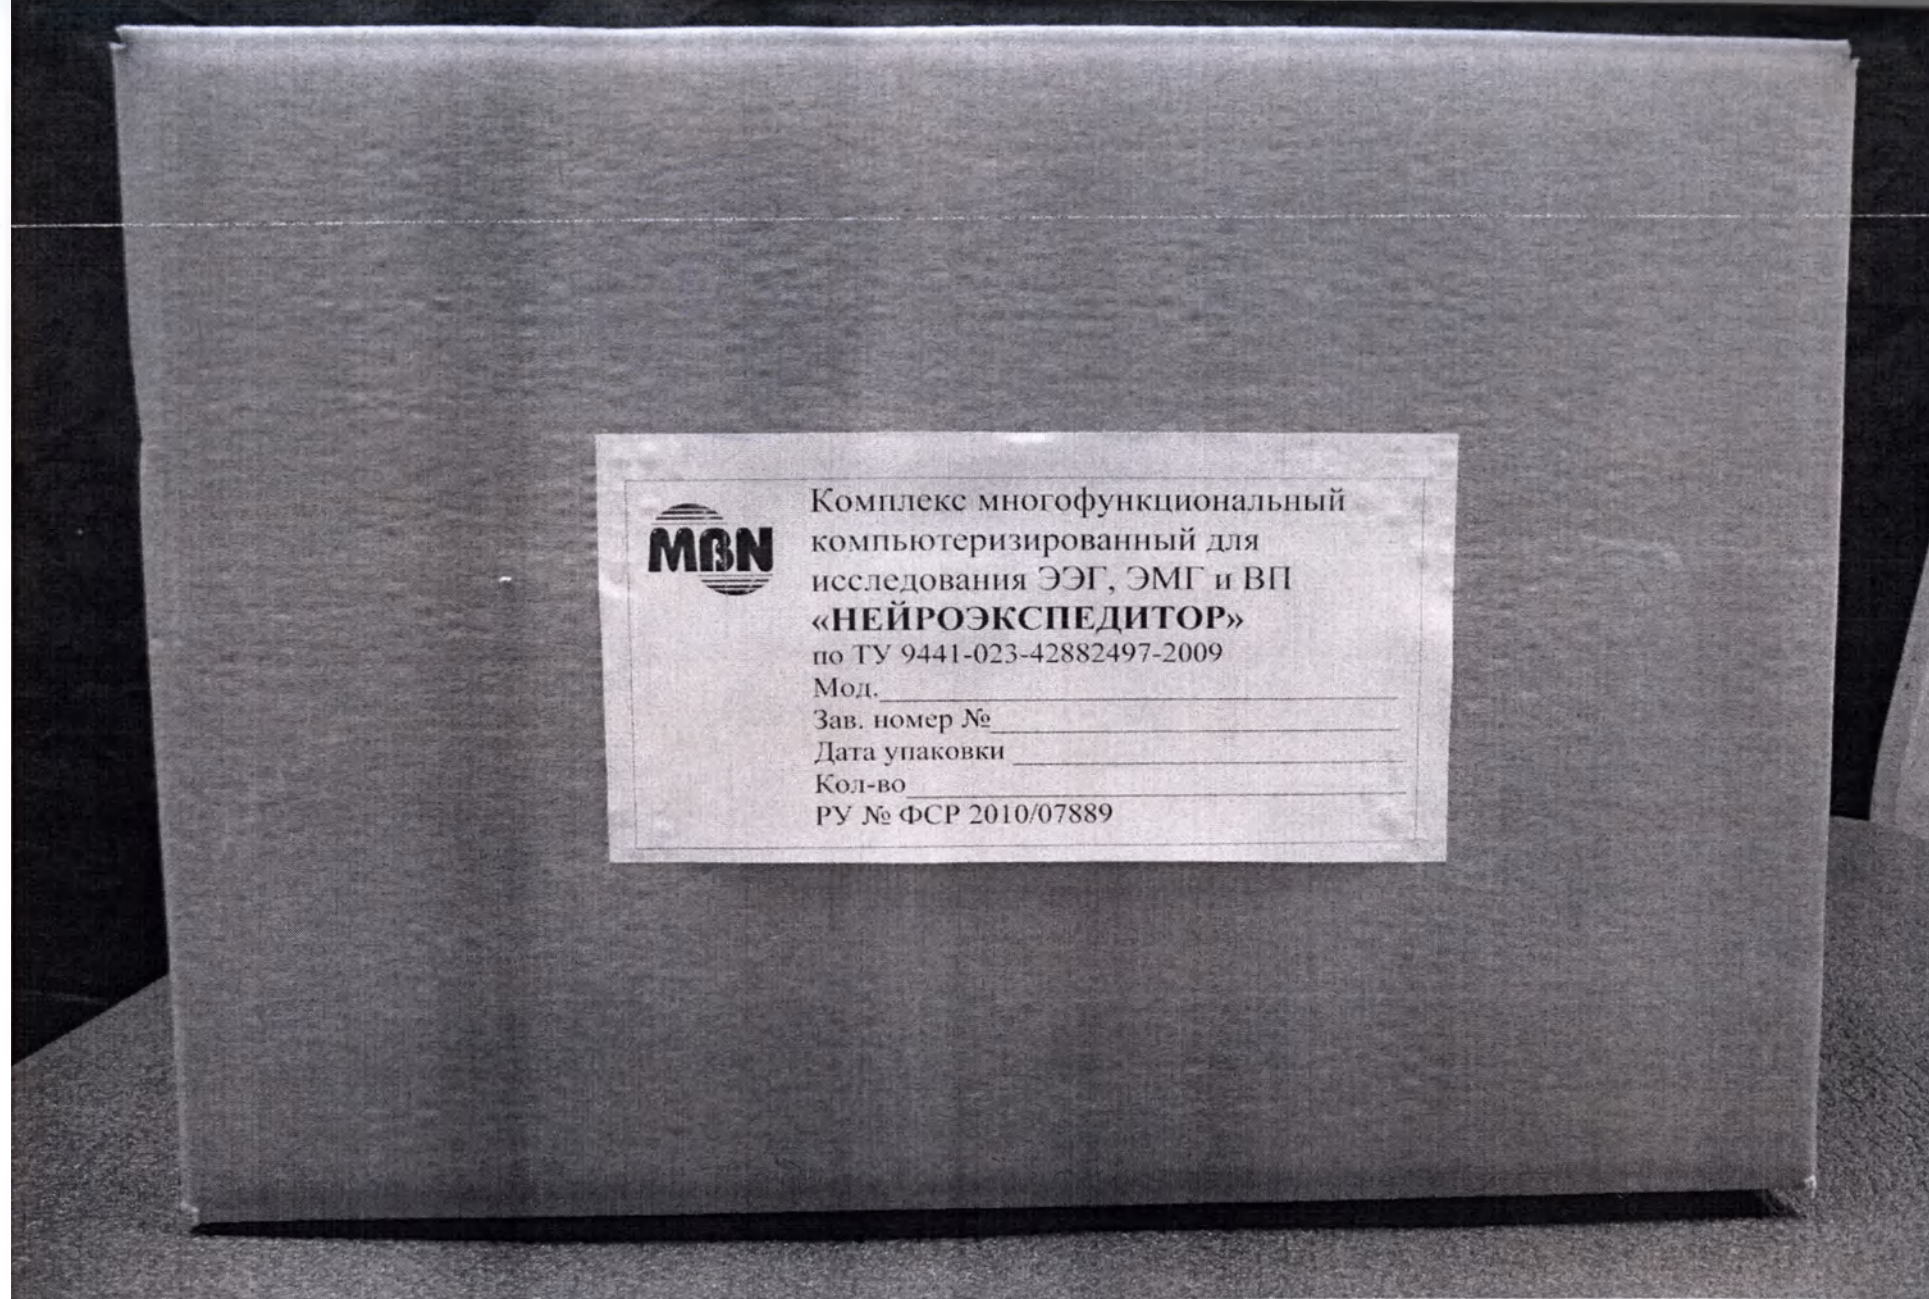


Фото 6 – Маркировка упаковки медицинского изделия: Комплекс многофункциональный компьютеризированный для исследования

ЭЭГ, ЭМГ и ВП «Нейроэкспедитор» по ТУ 9441-023-42882497-2009

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
листа (ов)

