(18)

Dräger

Фотографические изображения

«Билирубинометр JM105», производства

«Draeger Medical Systems, Inc.» («Дрегер Медикал Системз, Инк.»), США

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

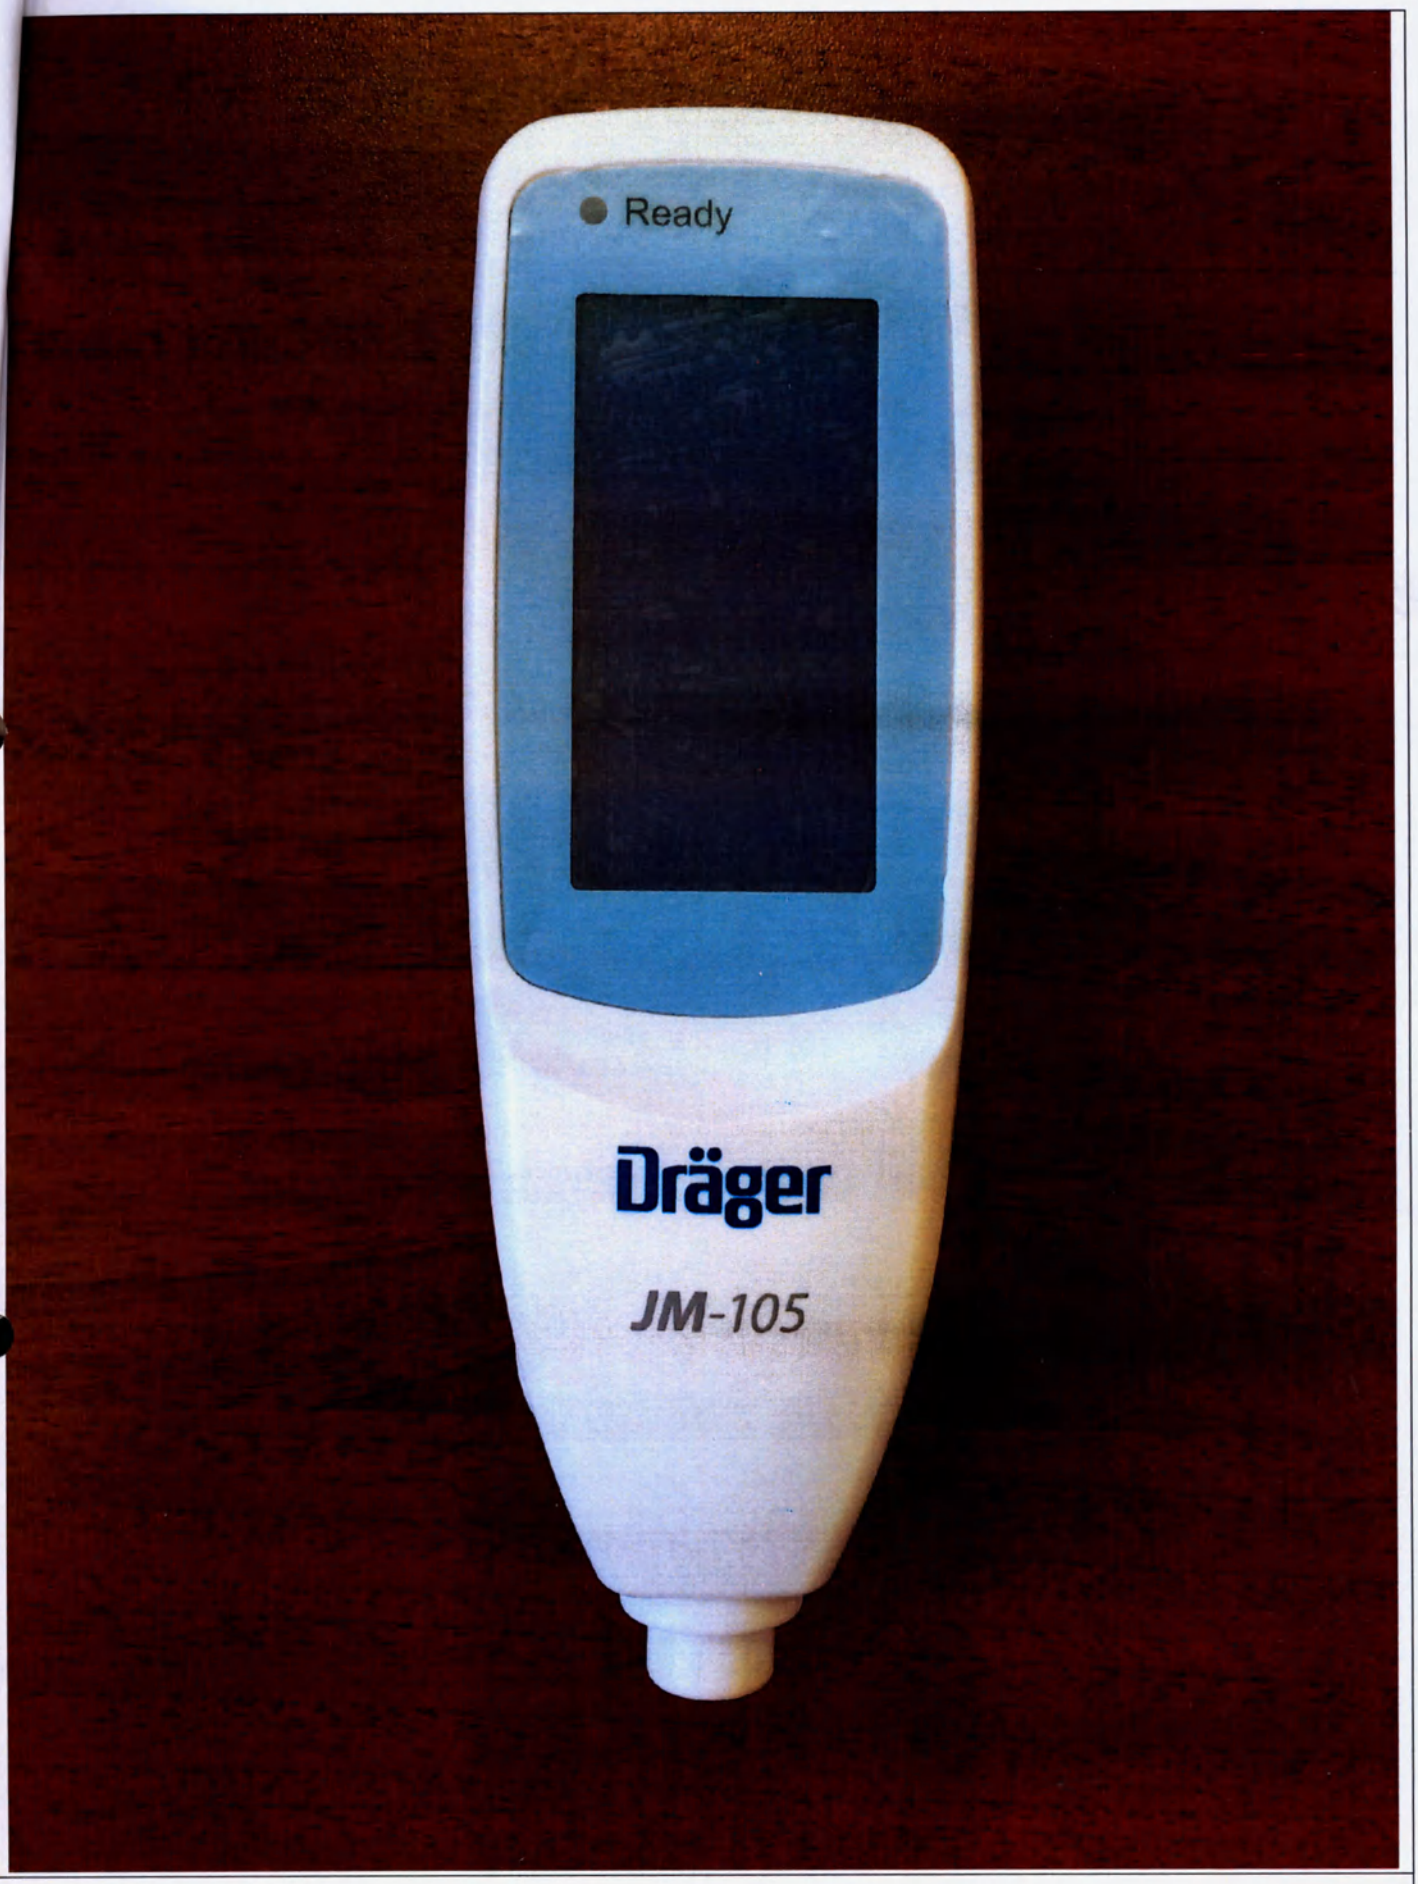

1. Билирубинометр JM105

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Док-станция JM-A33.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Сетевой адаптер JM-A32.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Кабель питания (16А; 250V).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

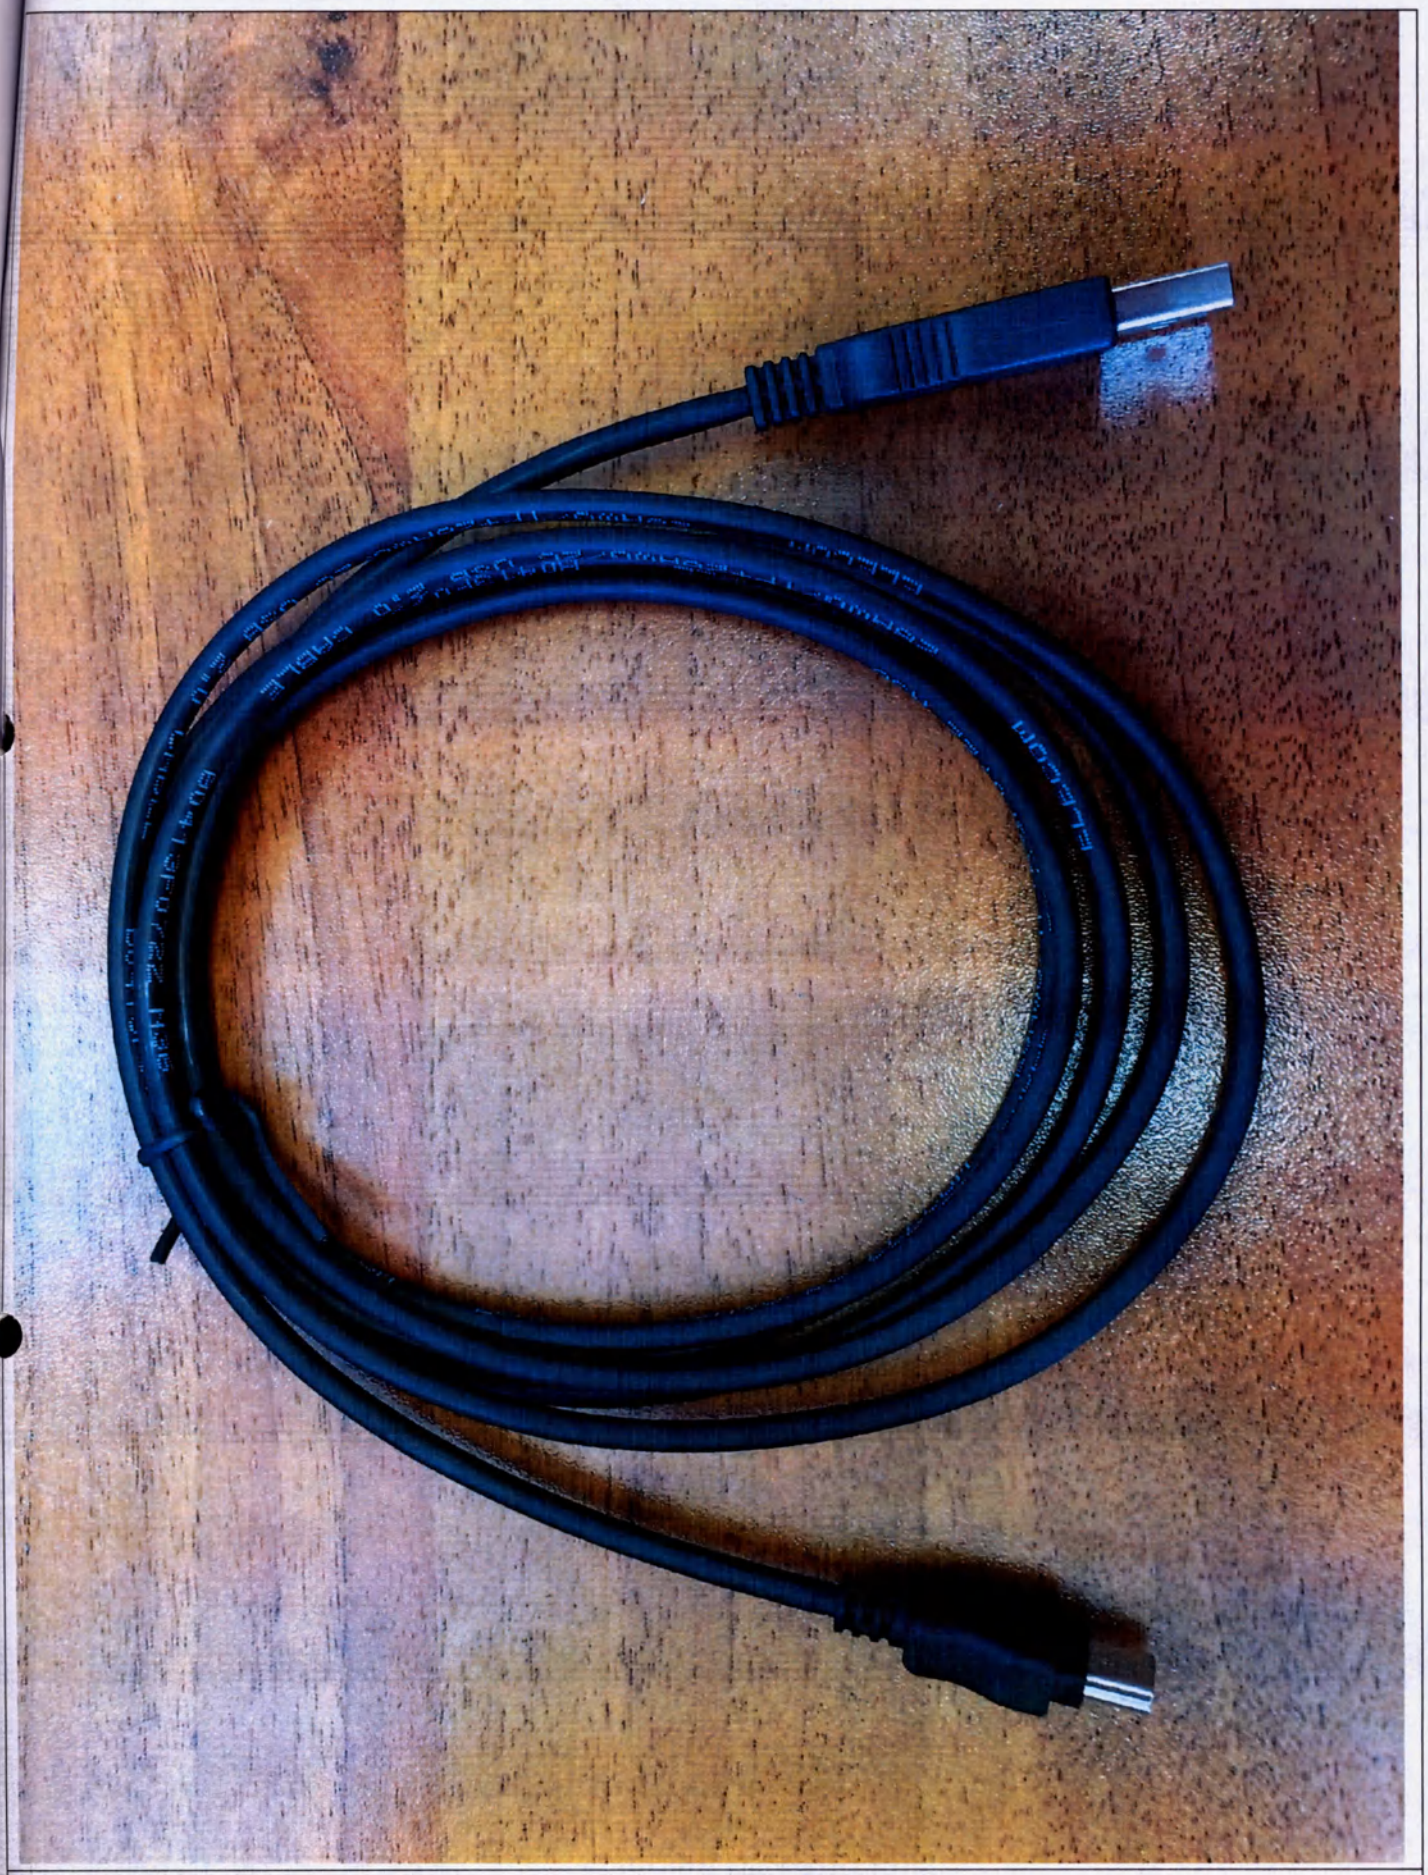

5. USB – кабель (2.0).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Программное обеспечение для передачи данных JM-S1w.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Руководство по эксплуатации на русском языке, печатное.

Dräger

Руководство по эксплуатации

JM-105

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для надлежащего применения этого медицинского аппарата изучите и соблюдайте данные инструкции по эксплуатации.

Билирубинометр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
2 листа (ов)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU