

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

SulcoFix
Add-on

Aspheric Optic

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002


STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.00
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : UAON
LENGTH : 12.75 POWER : +8.00
OPT.DIA : 6.20 Exp:2021-04
CPHSAIKROC00002

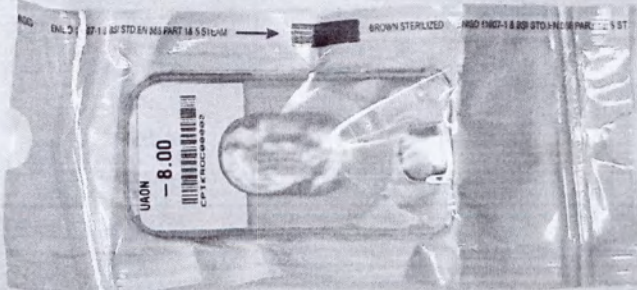

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж»
Sulcofix Add-on

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» – одноразовое стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции псевдофакического глаза после первичной имплантации ИОЛ в капсульный мешок.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on. Модель UAON.
Общий вид изделия




LOT : CPH5A
OPT.DIA: 6.20
POWER : -8.00

STYLE : UAON
LENGTH : 12.75
A CONST: 0.0
Exp Date : 2021-04

eyeol

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

Sulco Fix
Add-on

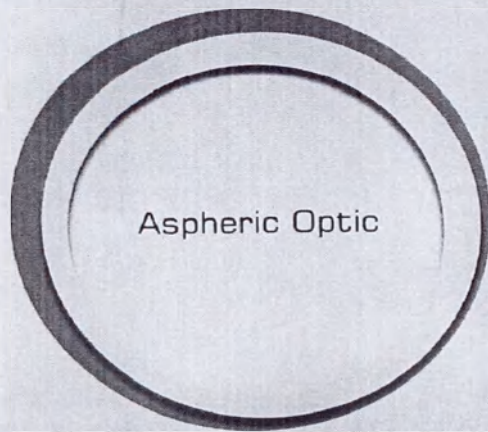

Aspheric Optic



CPH5A1KROC00002

2018-05 2021-04



Press
to tear

eyeol

Sulco Fix
Add-on

CPH5A1KROC00002

Rev. on. 03/2018

- One Sterile Intraocular Lens With UV Absorber. Do Not Use If The Packaging Is Damaged. Do Not Resterilize.
- Eine Sterile Intraokularlinse Mit UV-Filter. Nicht Verwenden Wenn Die Verpackung Beschädigt Ist. Nicht Resterilisieren.
- Одна Стерильная Интраокулярная Линза С УФ-Фильтром. Не Использовать, Если Упаковка Повреждена. Не Стерилизовать Повторно.
- Une Lentille Intraoculaire Avec Filtre UV. Ne Pas Utiliser Si L'emballage Est Endommagé. Ne Pas Resteriliser.
- En Steril Intraokulär Lins Med UV-absorbent. Använd Inte Om Förpackningen Är Skadad. Resterilisera Inte.
- En Steril Intraokulär Linse Med UV Absorber. Ikke Bruk Hvis Emballagen Er Skadet. Ikke Resterilis.
- Una Lente Intraocular Estéril Con Absorción De UV. No Lo Use Si El Paquete Está Dañado. No Resterilizar.
- Una Lente Intraocular Sterile Con Filtro UV. Non Usare Se La Confezione È Danneggiata. Non Resterilizzare.
- Uma lente intra-ocular estéril com filtro UV. Não usar se a embalagem estiver danificada. Não reesterilizar.
- En Steril Intraokulär Linse Med UV Absorber. Brug Ikke, Hvis Emballagen Er Beskadiget. Ikke Resterilis.
- Een Steriele Intra-oculaire Lens Met UV-absorber. Niet Gebruiken Als De Verpakking Is Beschadigd. Niet Opnieuw Steriliseren.

Contents:

- One (1) Sterile Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens. Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet
- Patient Lens Implant Identification Card
- Patient Record Labels


Includes Disposable
Injector and Cartridge



Code: 042-01055-0/28-1321
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre,
Boscobabe Road, Dunstable,
Bedfordshire LU5 4SB, U.K.
Fax: +44 (0) 1582 607009
Phone: +44 (0) 1582 477002
Email: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk

STERILE

CE
2460



eyeol

Sulco Fix
Add-on

Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on: модель UAON.
Потребительская упаковка (коробка)

IMAGED

EN ISO 11607-1 & BSI STD. EN 868 PART 1 & 5 STEAM

BROWN STERILIZED

EN ISO 11607-1 & BSI STD. EN 868 PART 1 & 5 ST

UAON

- 8.00



CP1KROC00002

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

STYLE : UAON

POWER : -8.00 LOT: CPH5A

LENGTH : 12.75 : 2018-05


OPT. DIA : 6.20 : 2021-04

A.CONST : 0.0

EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre,
Boscombe Road, Dunstable,
Bedfordshire LU5 4SB, U.K.
Web: www.eyool.co.uk



**Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on. Модель UAON.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)**

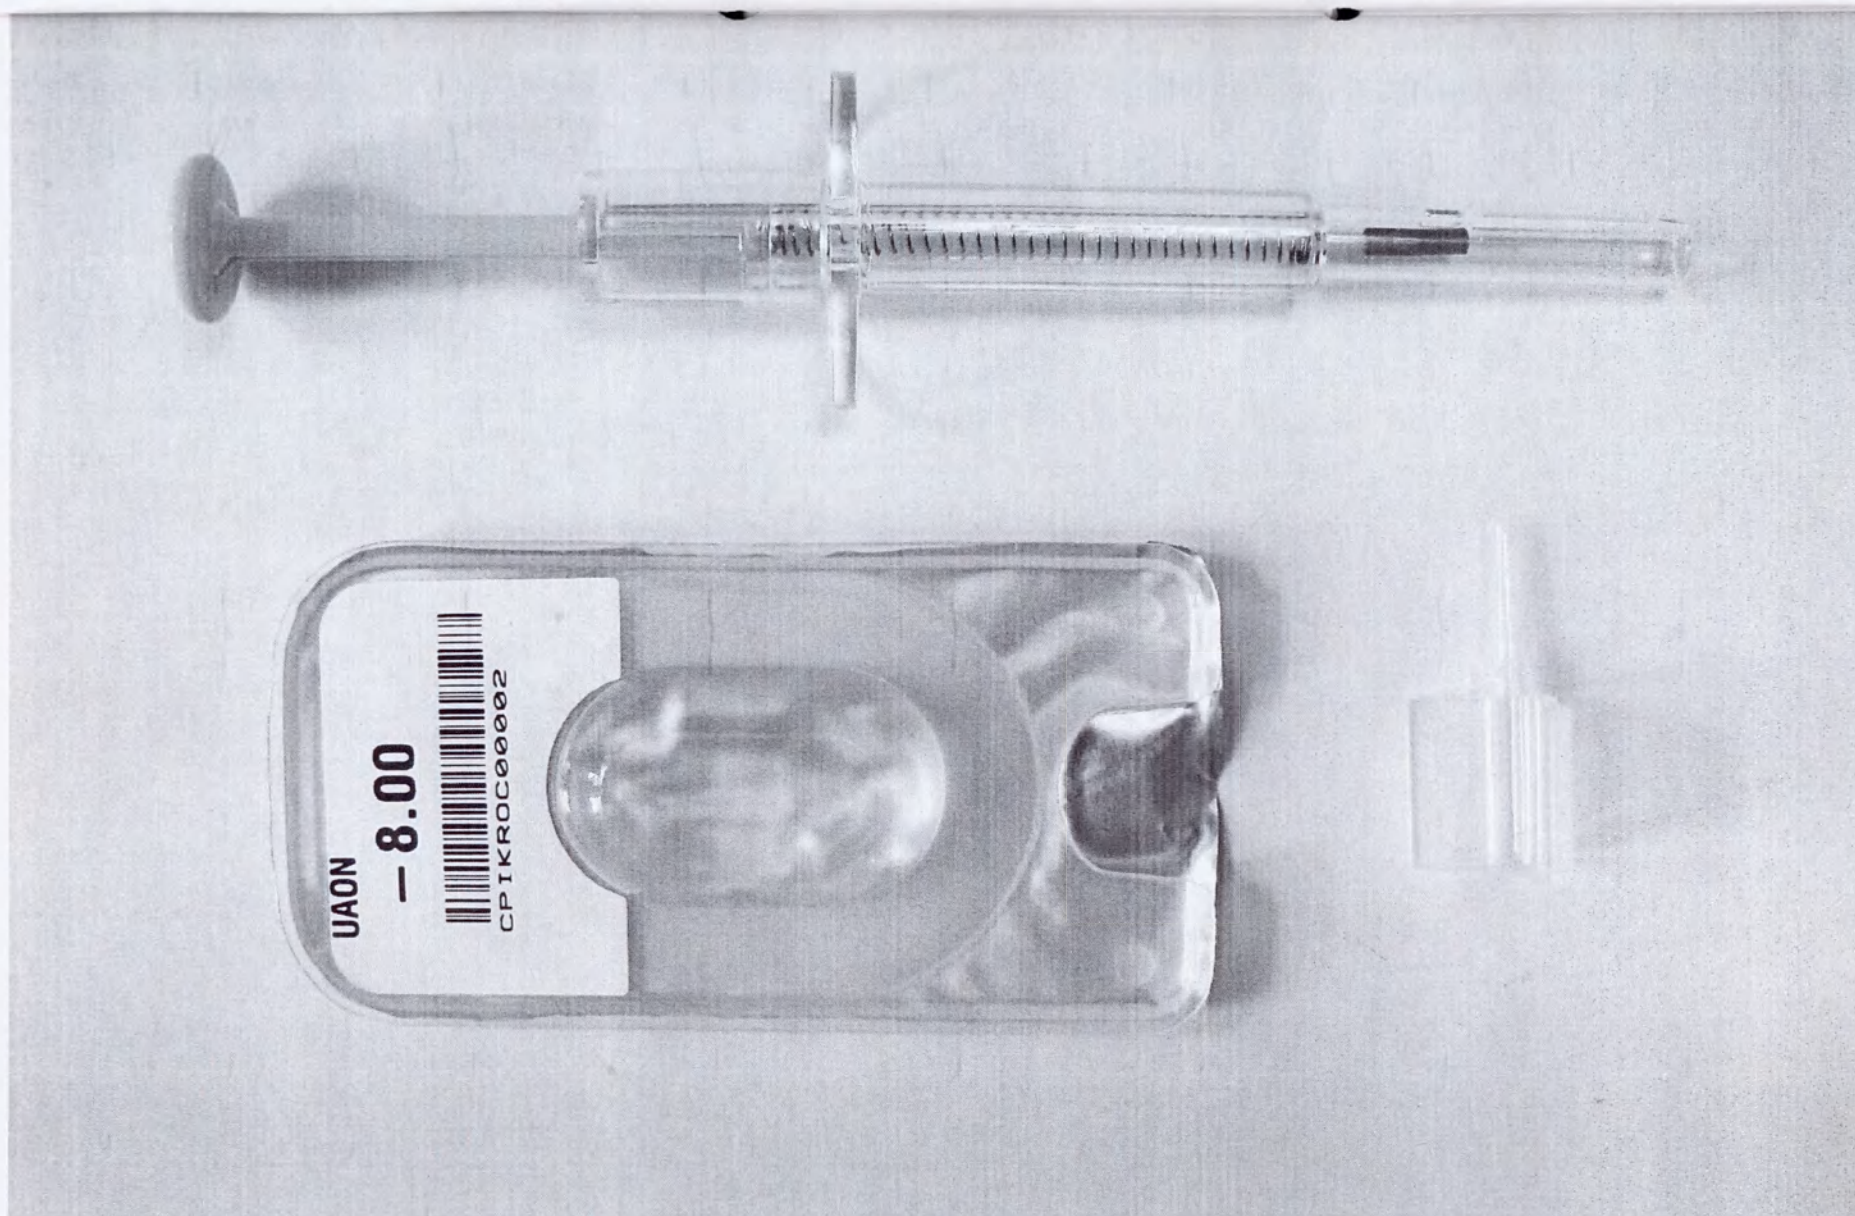

**Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on. Модель UAON.
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.**

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

EYE PCL V2.0 **IMPLANTABLE** **PHAKIC Lens**

Aspheric Optic

Precise

Date

Reversible

Инструкция по применению медицинского изделия
 «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж»
 EyePCL V2.0

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» однократное стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения: офтальмохирургия.

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

STYLE:EPCL125 *
 LENGTH :12.50
 OPT.DIA :6.60
 POWER :+5.00
 Exp:2021-05
 CPT 9999 4000000036

Patient's Name :

Implant Surgeon's Name :

Date of Surgery :

Implanted Eye : () R () L

STYLE : EPCL125 *

LENGTH : 12.50


OPT.DIA : 6.60

POWER : +5.00


Exp:2021-05

CPT 9999 4000000036

Линза интраокулярная факичная EyePCL V2.0. Модель EPCL 125

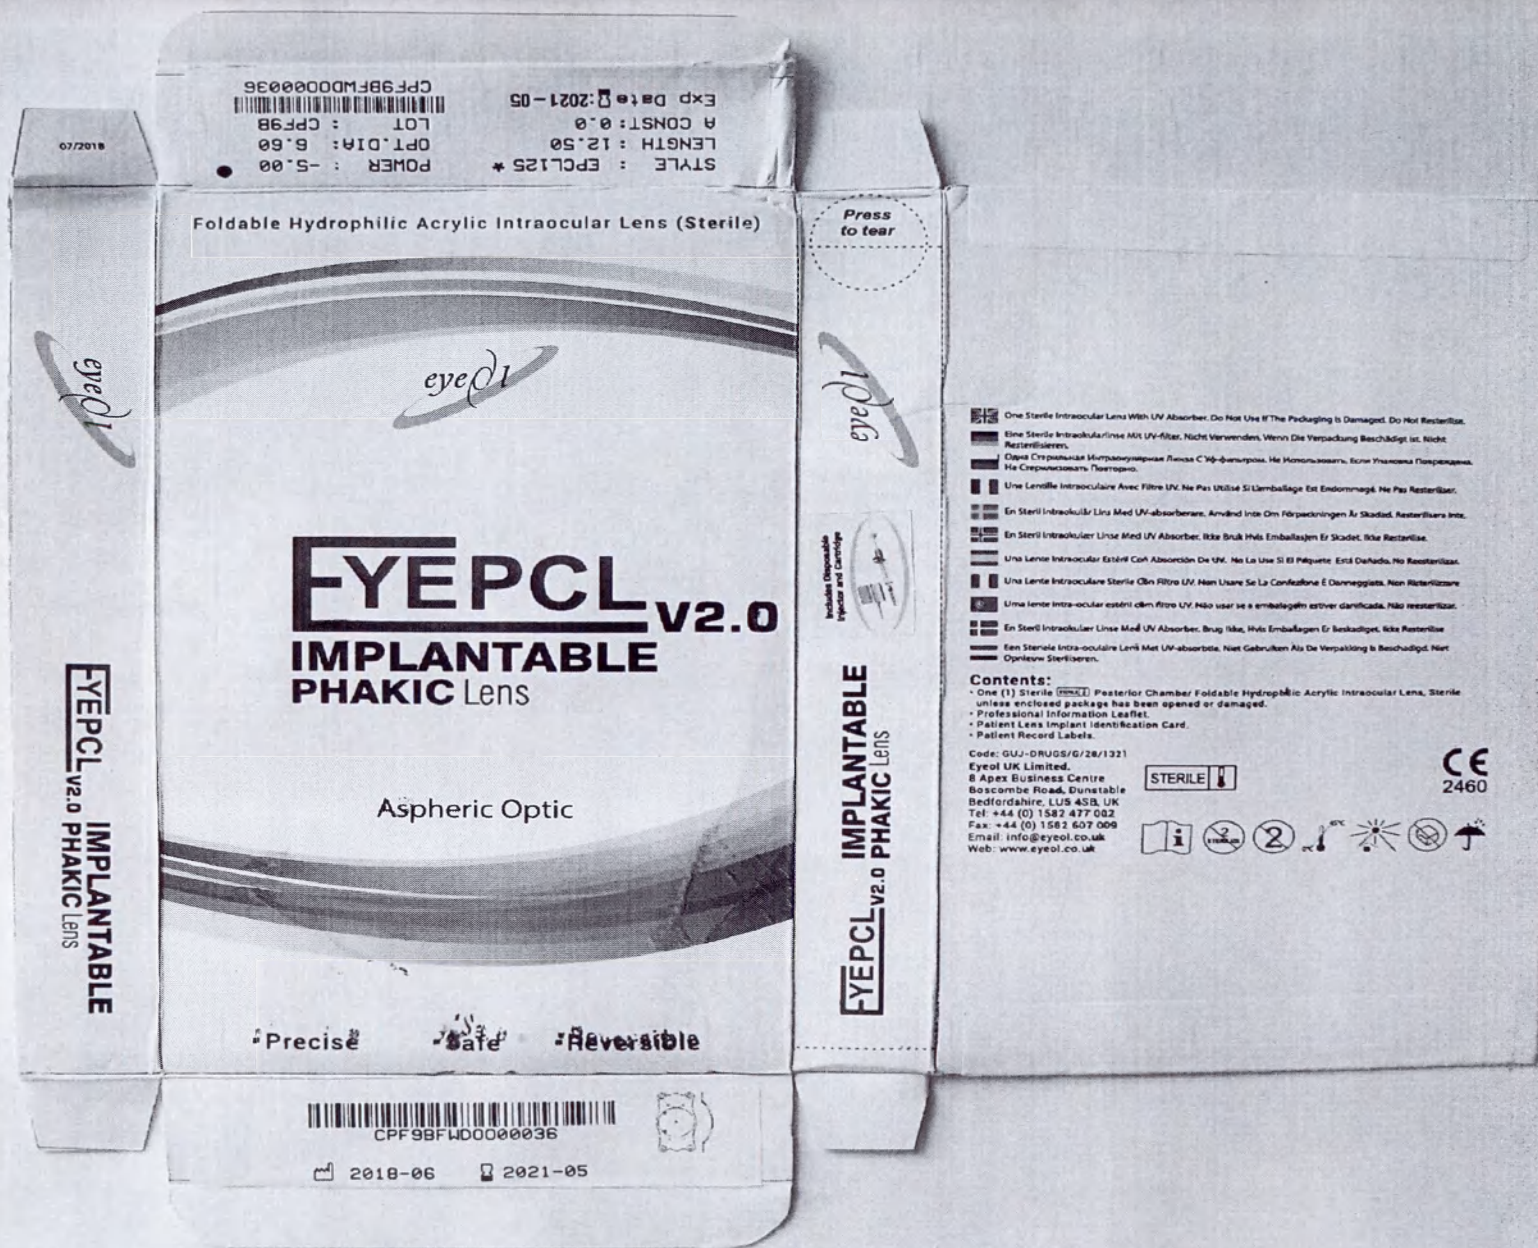


Линза интраокулярная факичная EyePCL V2,0: модель EPCL125
Потребительская упаковка (коробка)

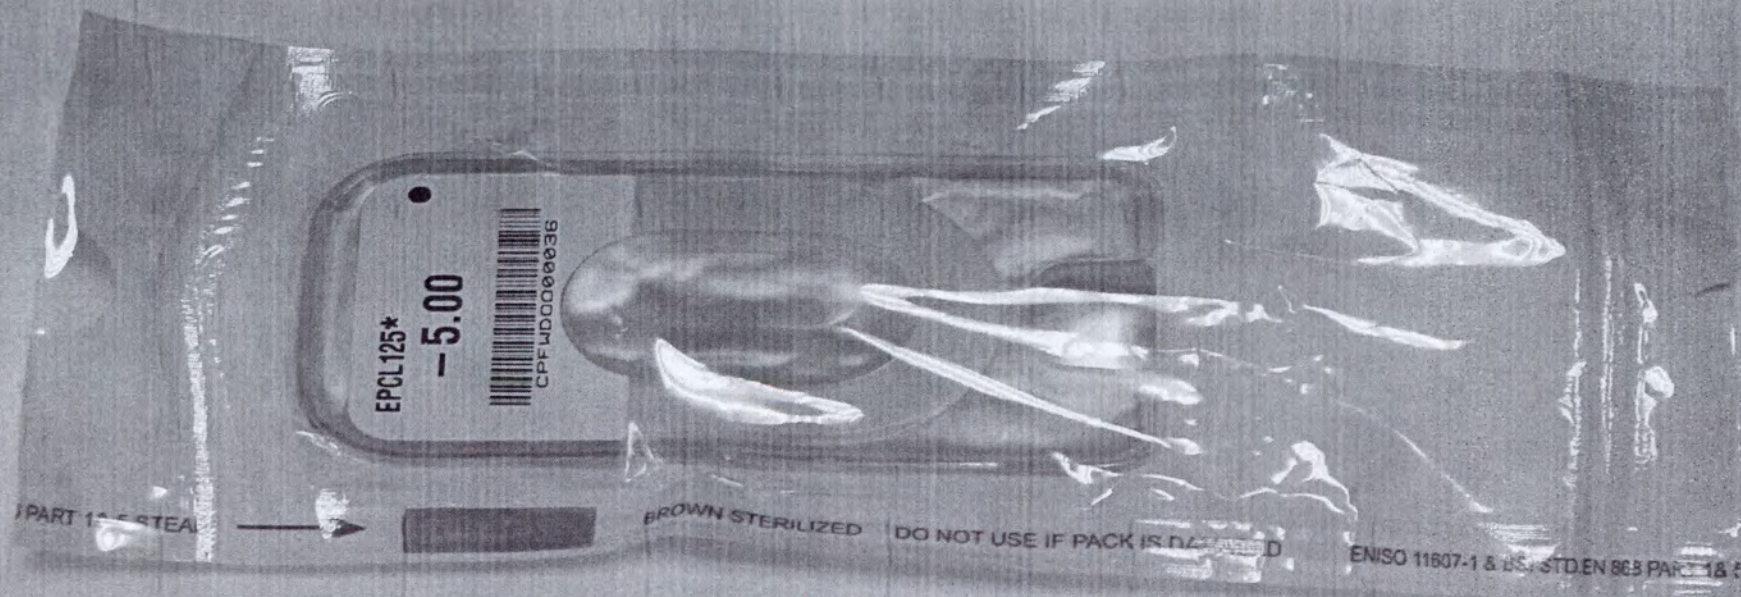


Foldable Intraocular Lens (Sterile)
STYLE : EPCL125 ★
POWER : -5.00 LOT: CPF9B
LENGTH : 12.50 ☐ : 2018-06
OPT.DIA : 6.60 ☐ : 2021-06
A.CONST : 0.0





EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre,
Boscombe Road, Dunstable,
Bedfordshire LU6 4SB, U.K.
Web: www.eyool.co.uk



Линза интраокулярная факичная EyePCL V2,0. Модель EPCL 125

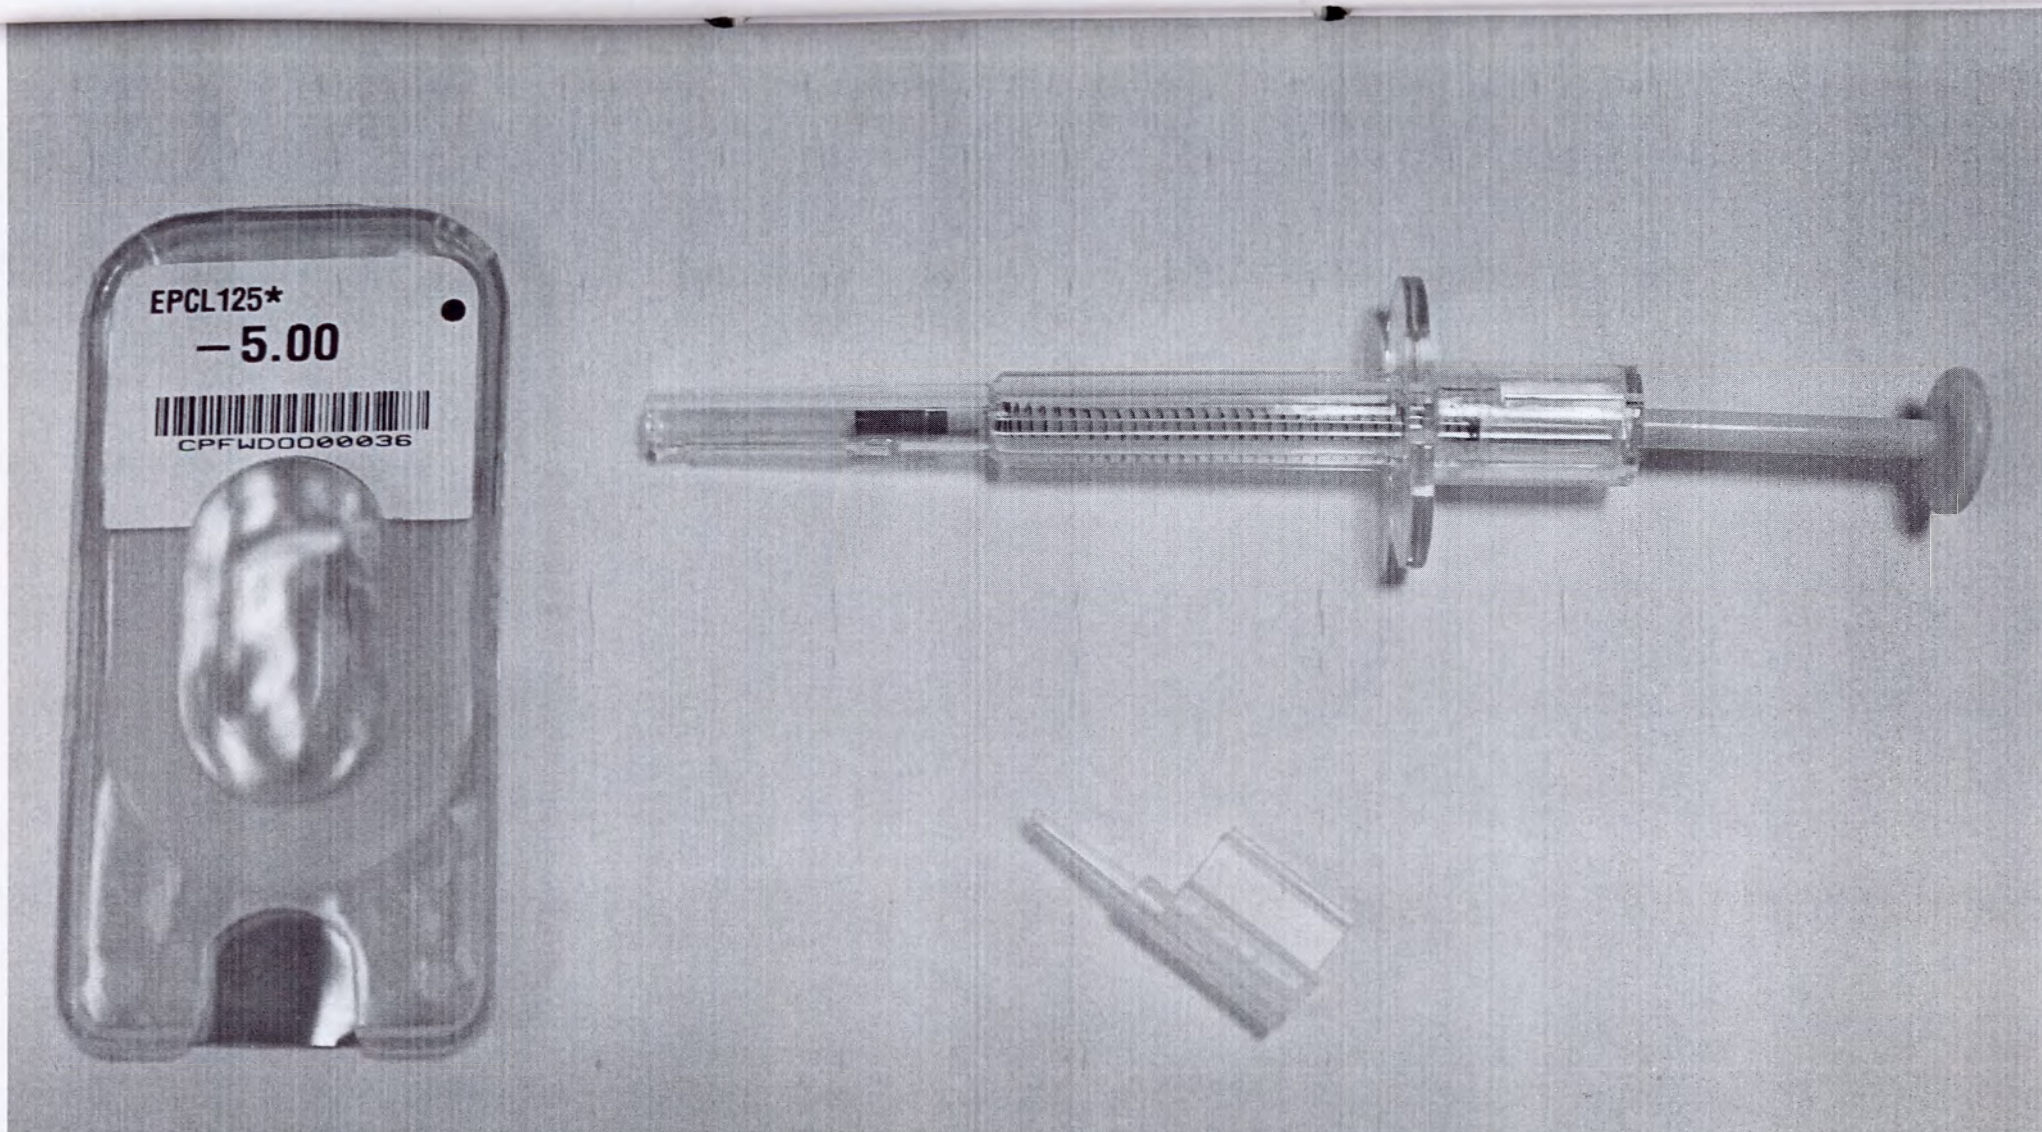

**Линза интраокулярная факичная EyePCL V2,0. Модель EPCL 125.
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.**

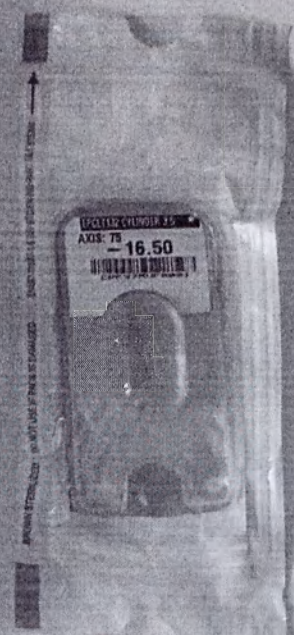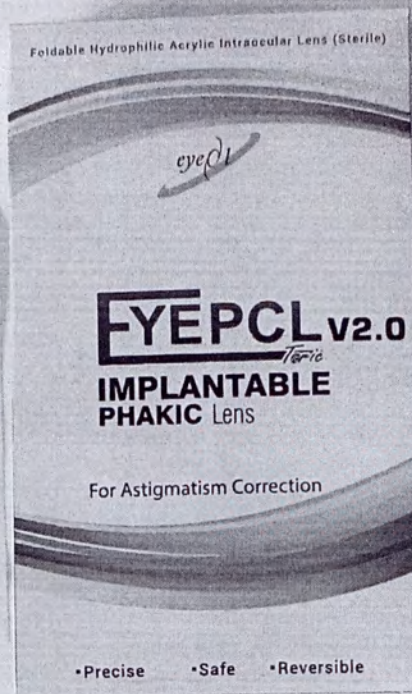

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факическая в составе: линза, инжектор и картридж»
EyePCL Toric V2.0

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факическая в составе: линза, инжектор и картридж» — одноразовое стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения - офтальмохирургия.

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

STYLE:EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : EPCLT132 * CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :--16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP55HF 377MF0001

Линза интраокулярная факическая EyePCL Toric V2,0. Модель EPCLT 132.

Общий вид изделия

07-2018

STYLE : EPCLT132 * CYLINDER 3.5
 AXIS : 75
 LENGTH : 13.25
 A CONST : 0.0
 Exp Date : 2021-06
 LOT : CPGSH
 OPT.DIA : 6.60
 POWER : -16.50

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

eyeol

eyeol

eyeol

EYE PCL v2.0 *Toric* **IMPLANTABLE** **PHAKIC Lens**

For Astigmatism Correction

• Precise • Safe • Reversible

CPGSHF37MUF0001

2018-07 2021-06

Includes Disposable
Implant and Cartridge

IMPLANTABLE
EYE PCL v2.0
Toric
PHAKIC Lens

Press
to tear


- One Sterile Intraocular Lens With UV Absorber. Do Not Use If The Packaging Is Damaged. Do Not Reuse.
 Eine Sterile Intraokularlinse Mit UV-Filter. Nicht Verwenden, Wenn Die Verpackung Beschädigt Ist. Nicht
 Reutilisieren.
 Одна Стерильная Интраокулярная Линза С УФ-фильтром. Не Использовать, Если Ущербена Упаковка.
 Не Стерилизовать Повторно.
 Une Lentille Intraoculaire Avec Filtre UV. Ne Pas Utiliser Si L'emballage Est Endommagé. Ne Pas Réutiliser.
 En Steril Intraokular Linse Med UV-Absorber. Använd Inte Om Förpackningen Är Skadad. Reanvända Inte.
 En Steril Intraokular Linse Med UV-Absorber. Ikke Bruk Hvis Emballagen Er Skadet. Ikke Reanvend.
 Una Linde Intraocular Estéril Con Absorción De UV. No Lo Use Si El Paquete Está Dañado. No Reutilizar.
 Una Linde Intraocular Steril Con Filtro UV. Non Usare Se La Confezione È Danneggiata. Non Resterilizzare.
 Uma Linde Intra-ocular estéril com filtro UV. Não usar se a embalagem estiver danificada. Não reutilizar.
 En Steril Intraokular Linse Med UV-Absorber. Brug Ikke Hvis Emballagen Er Beskadiget. Ikke Reanvend.
 Een Sterile Intra-oculaire Linse Met UV-absorber. Niet Gebruiken Als De Verpakking Is Beschadigd. Niet
 Opnieuw Steriliseren.

Contents:


- One (1) Sterile  Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens, Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet.
- Patient Lens Implant Identification Card.
- Patient Record Labels.

Code: GUJ-DRUGS/0/28/1321
 Eyeol UK Limited,
 8 Apex Business Centre
 Boscombe Road, Dunstable
 Bedfordshire, LU5 4SB, UK
 Tel: +44 (0) 1582 477 002
 Fax: +44 (0) 1582 607 009
 Email: info@eyeol.co.uk
 Web: www.eyeol.co.uk


STERILE

CE
2460

Линза интраокулярная факичная EyePCL Toric V2,0. Модель EPCLT
Потребительская упаковка (коробка)

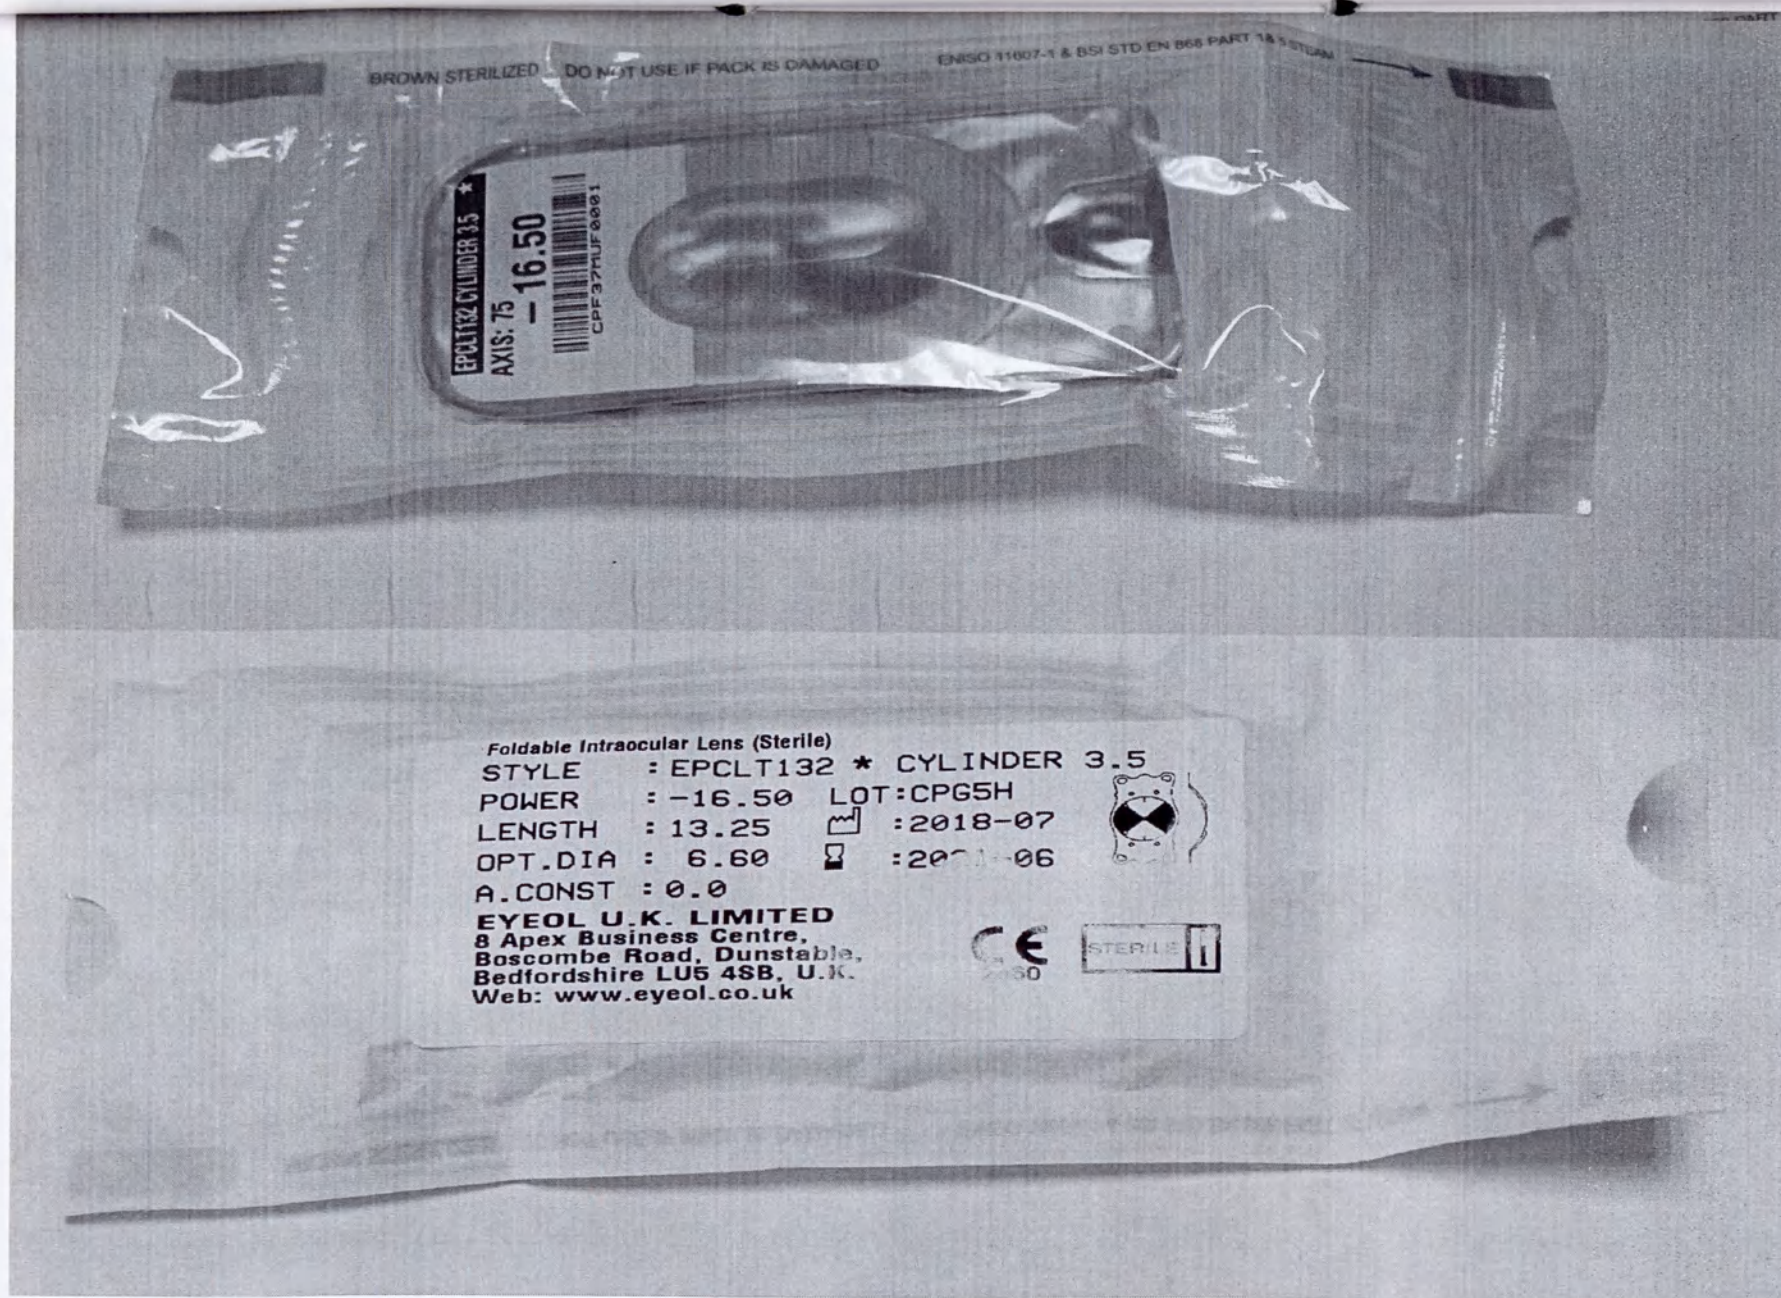


Линза интраокулярная факичная EyePCL Toric V2,0. Модель EPCLT 132
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

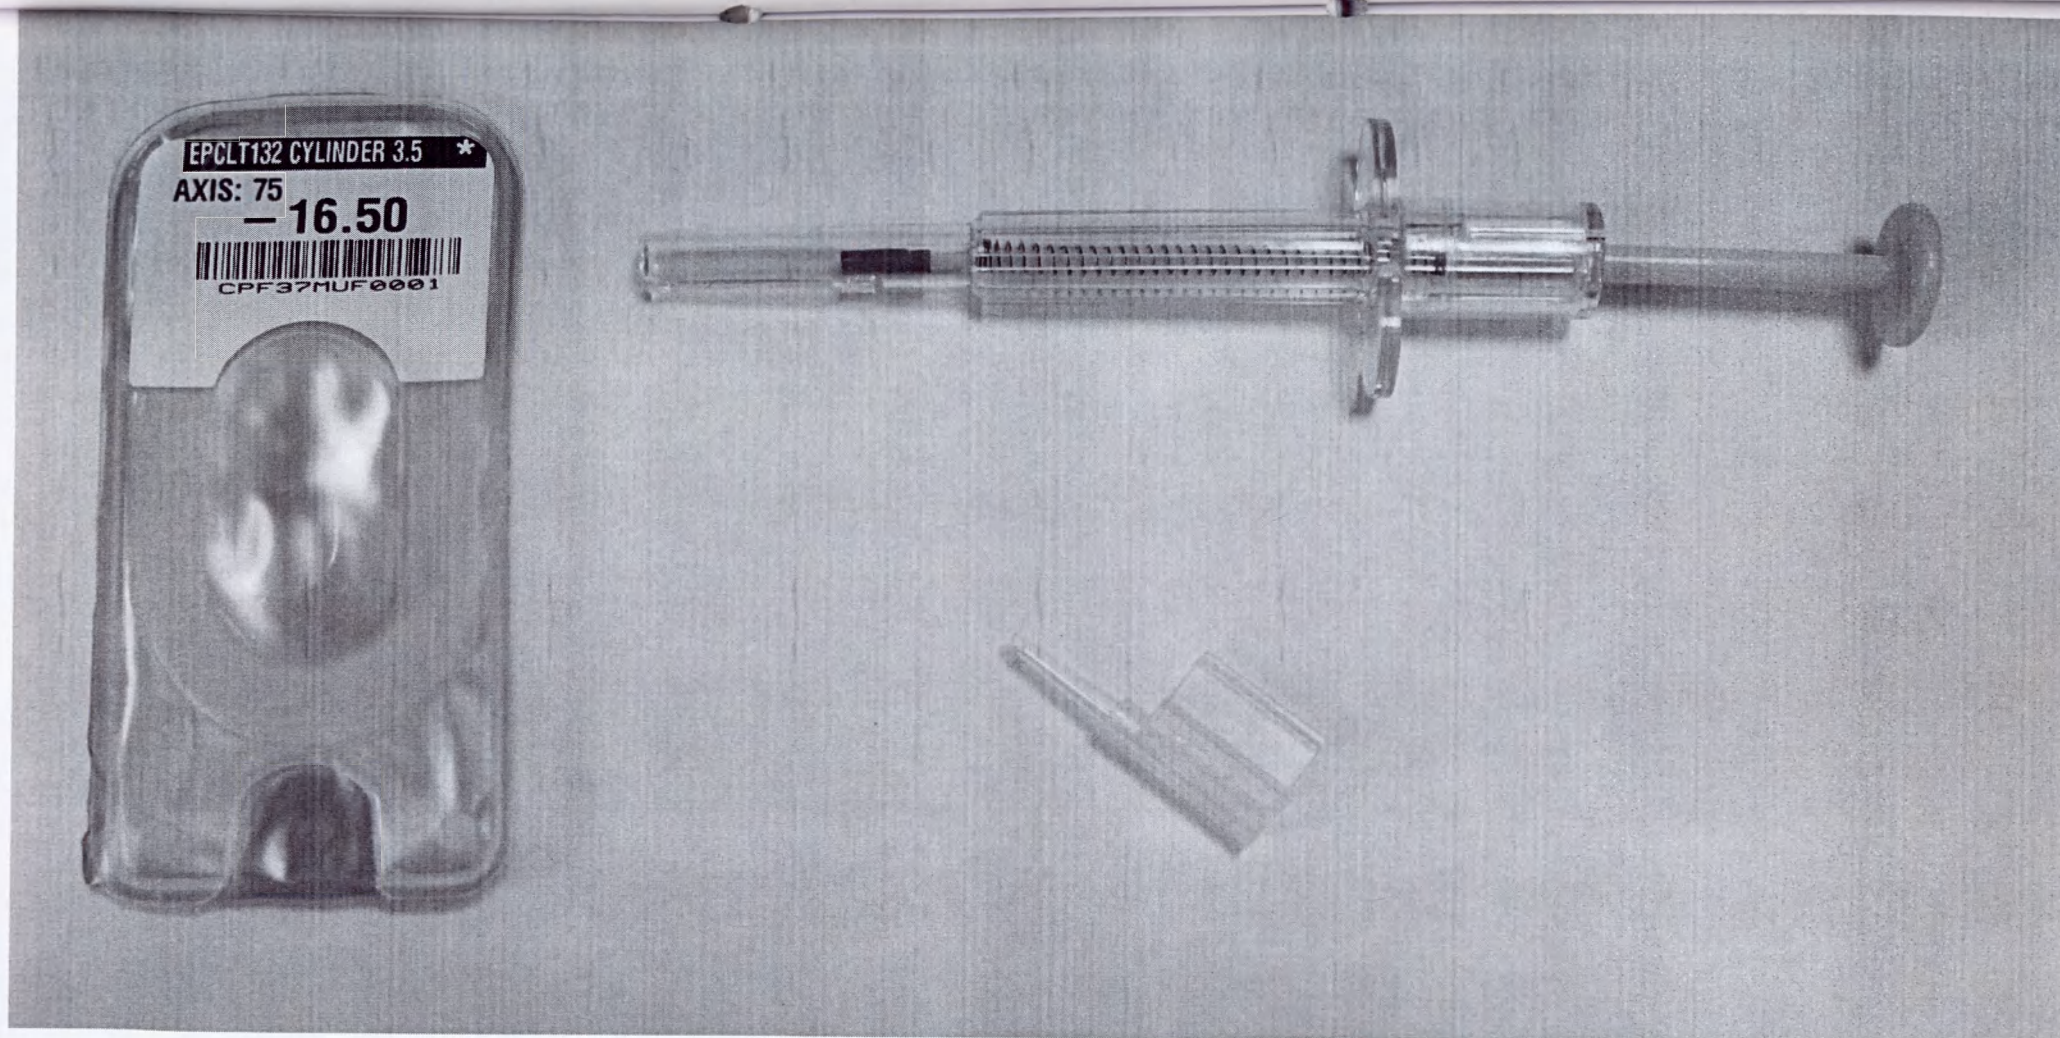

Линза интраокулярная факичная EyePCL Toric V2,0. Модель EPCLT 132
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

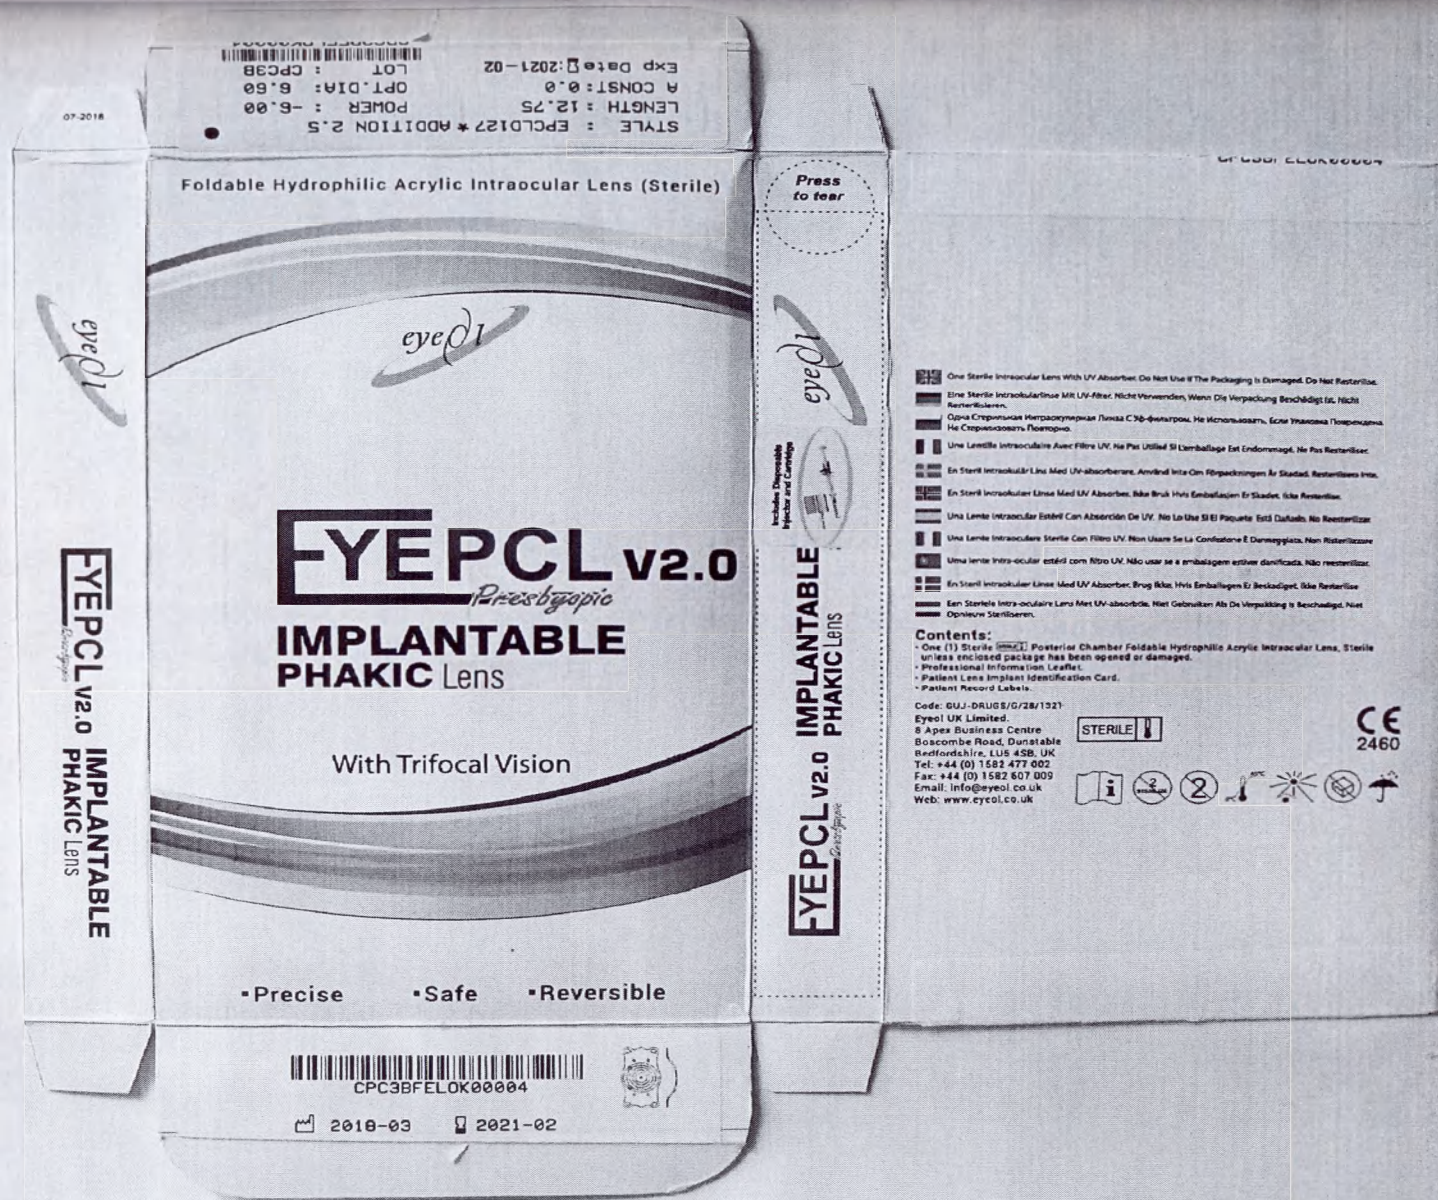

Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbyopic V2,0. Модель EPCLD 127
Потребительская упаковка (коробка)

Foldable Intraocular Lens (Sterile)
STYLE : IPCLD127 ★ ADDITION 3.0
POWER : -1.50 LOT:CPG3D
LENGTH : 12.75 :2018-07
OPT.DIA : 6.60 :2021-06
A.CONST : 0.0

EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre,
Boscombe Road, Dunstable,
Bedfordshire LU5 4SB, U.K.
Web: www.eyeol.co.uk

CE
2460


STERILE

EN ISO 11607



STD. EN 868 PART 1 & 5 STEAM

BROWN STERILIZED DO NOT USE IF PACK IS DAMAGED

Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbyopic V2,0
Модель EPCLD 127.

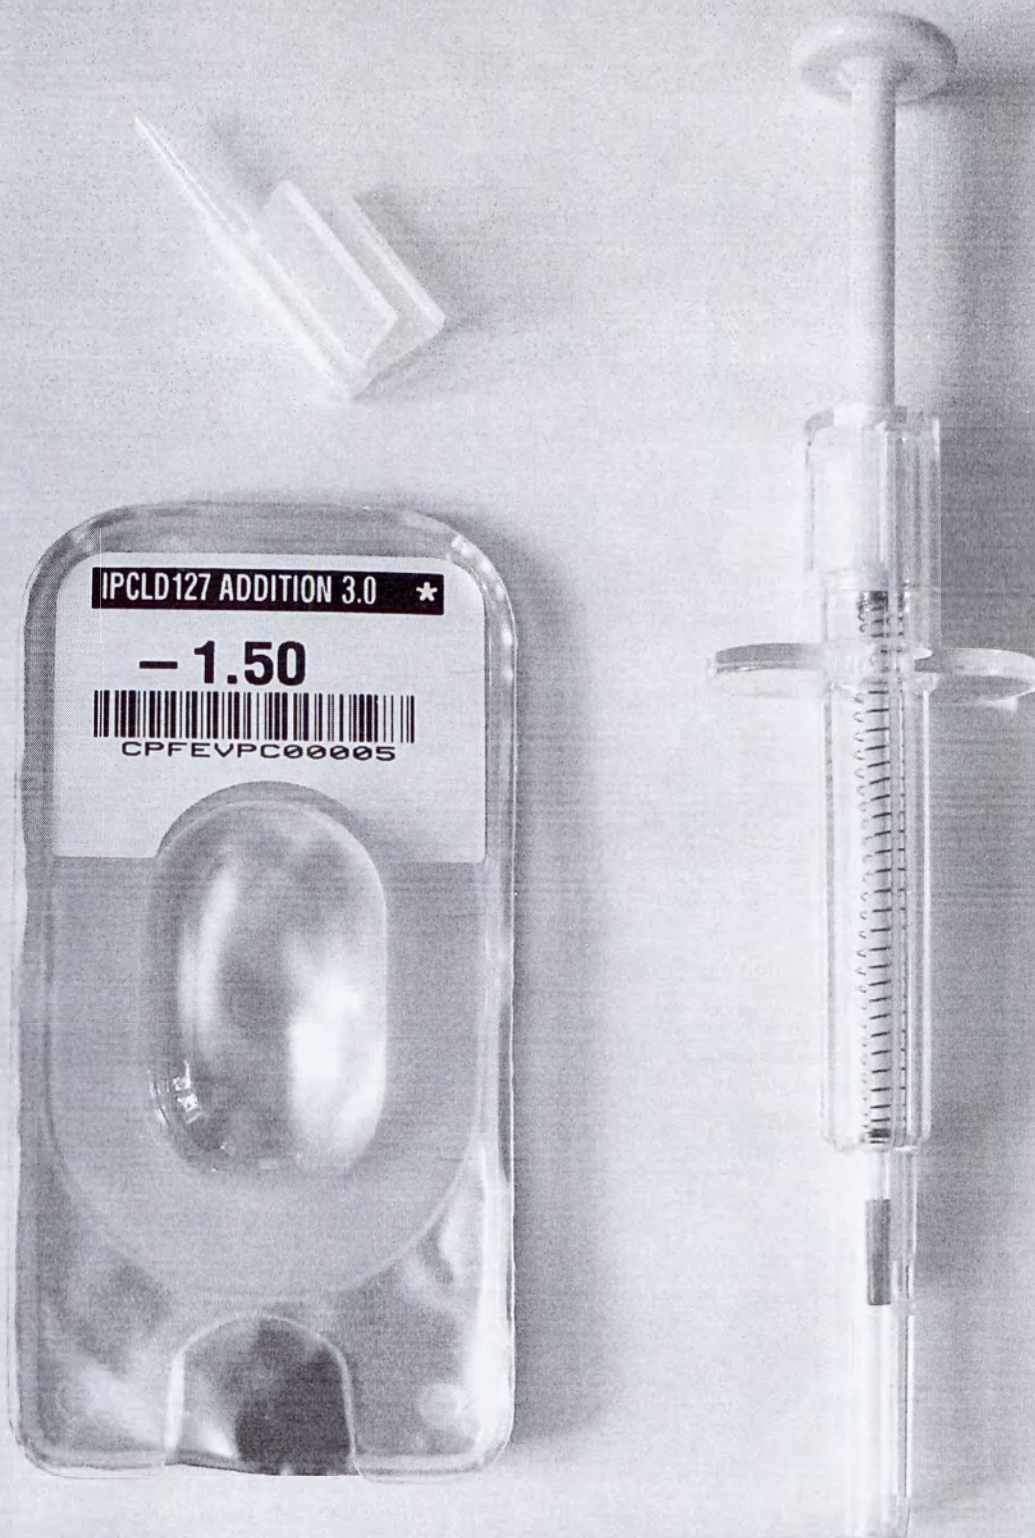

Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbiopic V2,0
Модель EPCLD 127
Контейнер с линзой, инжектор и картридж

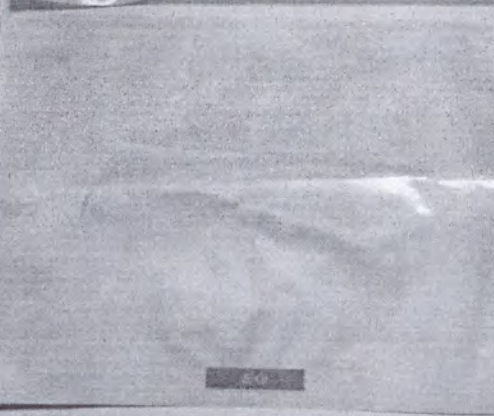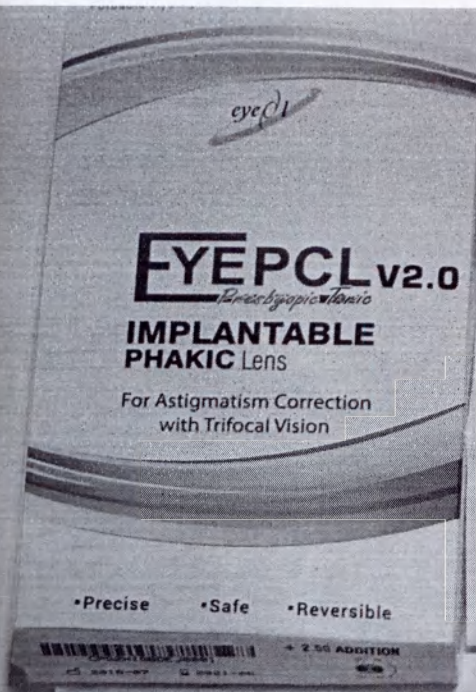

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж»
EyePCL Presbyopic Toric V2.0

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» – одноразовое стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения: офтальмохирургия.

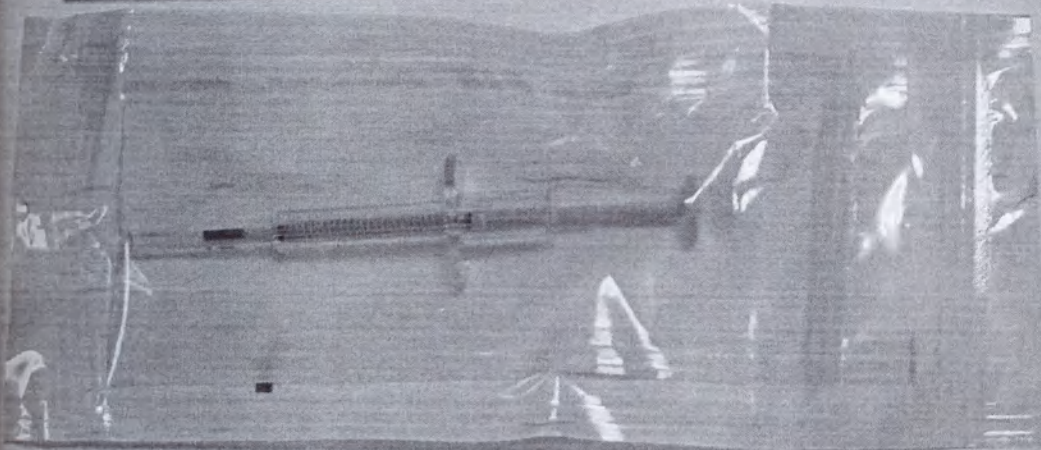

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06


STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06


STYLE:EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA 6.60 Exp:2021-06

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L
STYLE: EPCLDT122 * CYLINDER 3.5
LENGTH 112.25 POWER 1-7.50
OPT.DIA: 6.60 Exp:2021-06
STERILIZATION: 0001


Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbyopic Toric V2.0. Модель EPCLDT 122
Общий вид изделия

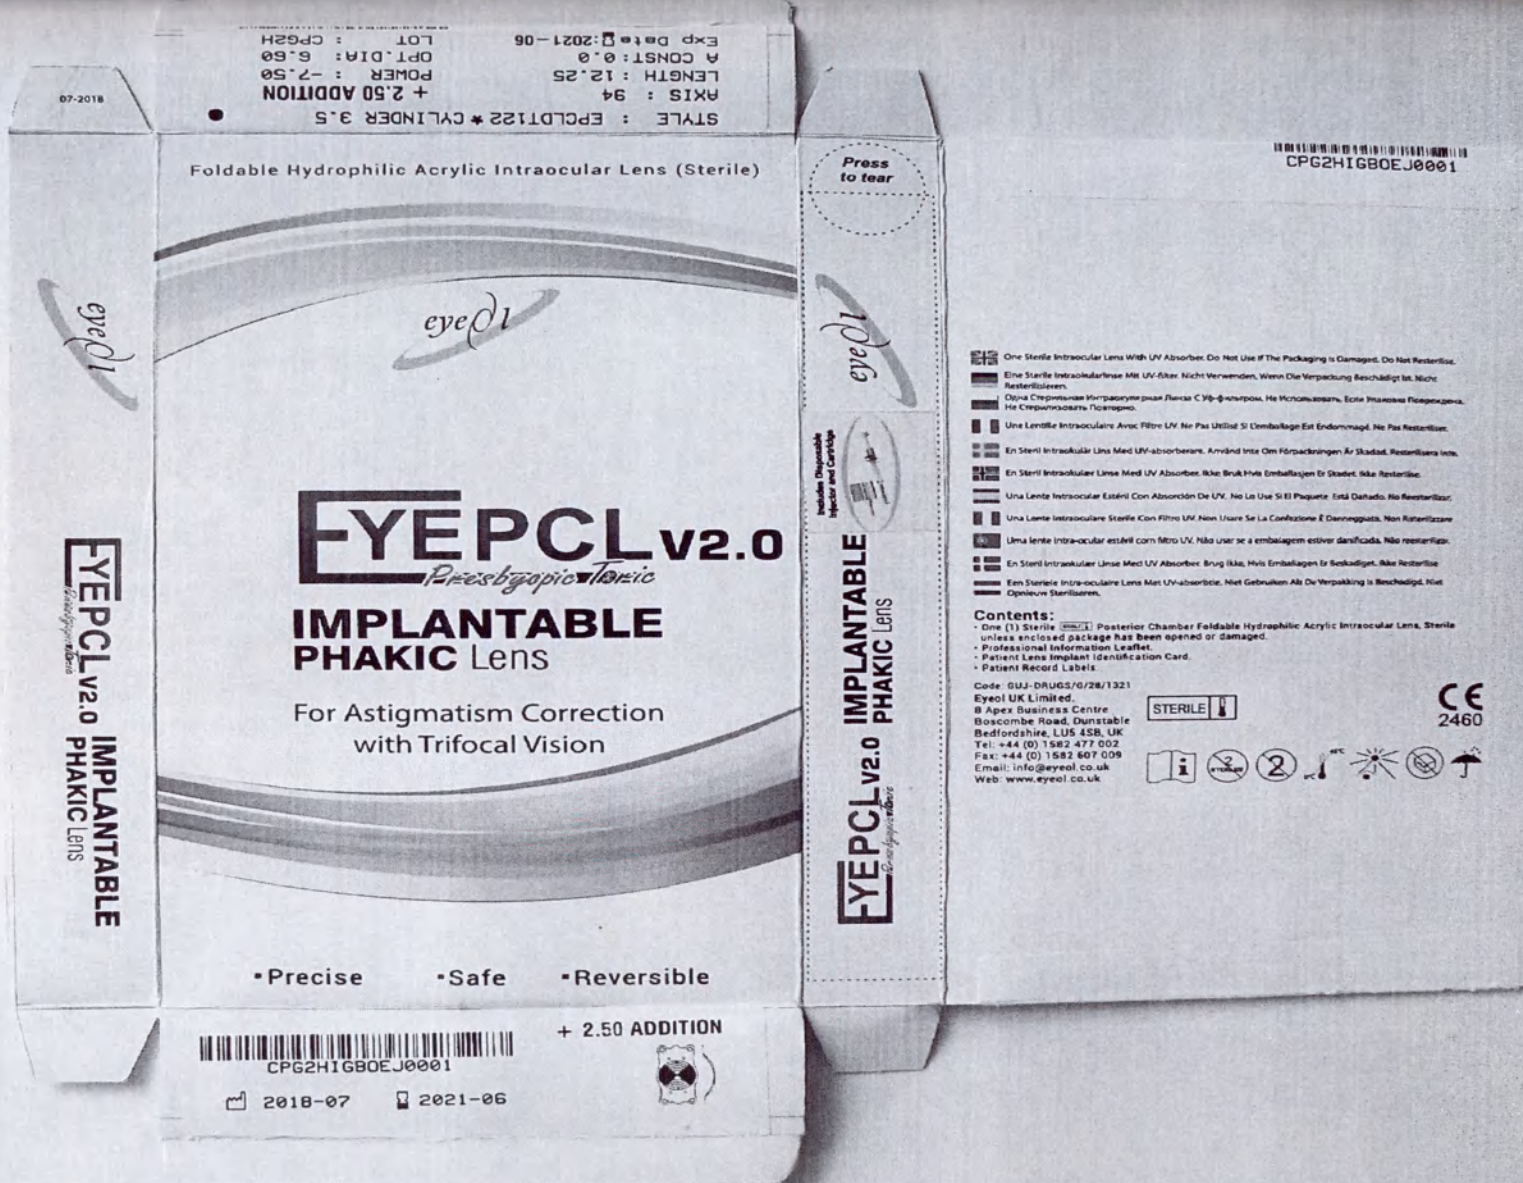


Линза интраокулярная факичная EyePCL Presnyopic Toric V2,0: модель EPCLDT122
Потребительская упаковка (коробка)

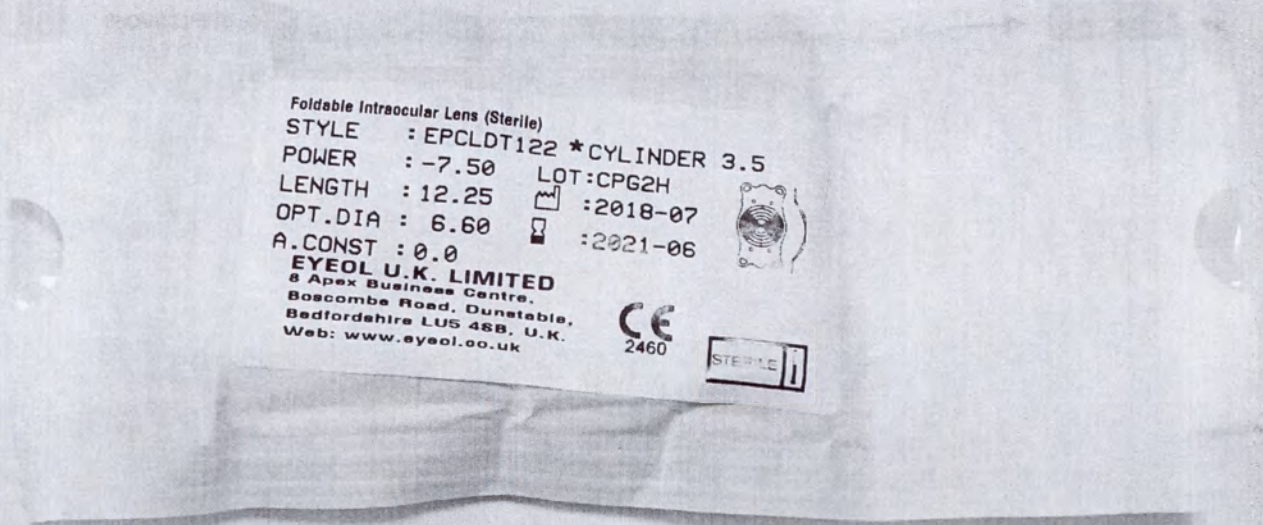

Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbyopic Toric V2,0. Модель EPCLDT 122
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

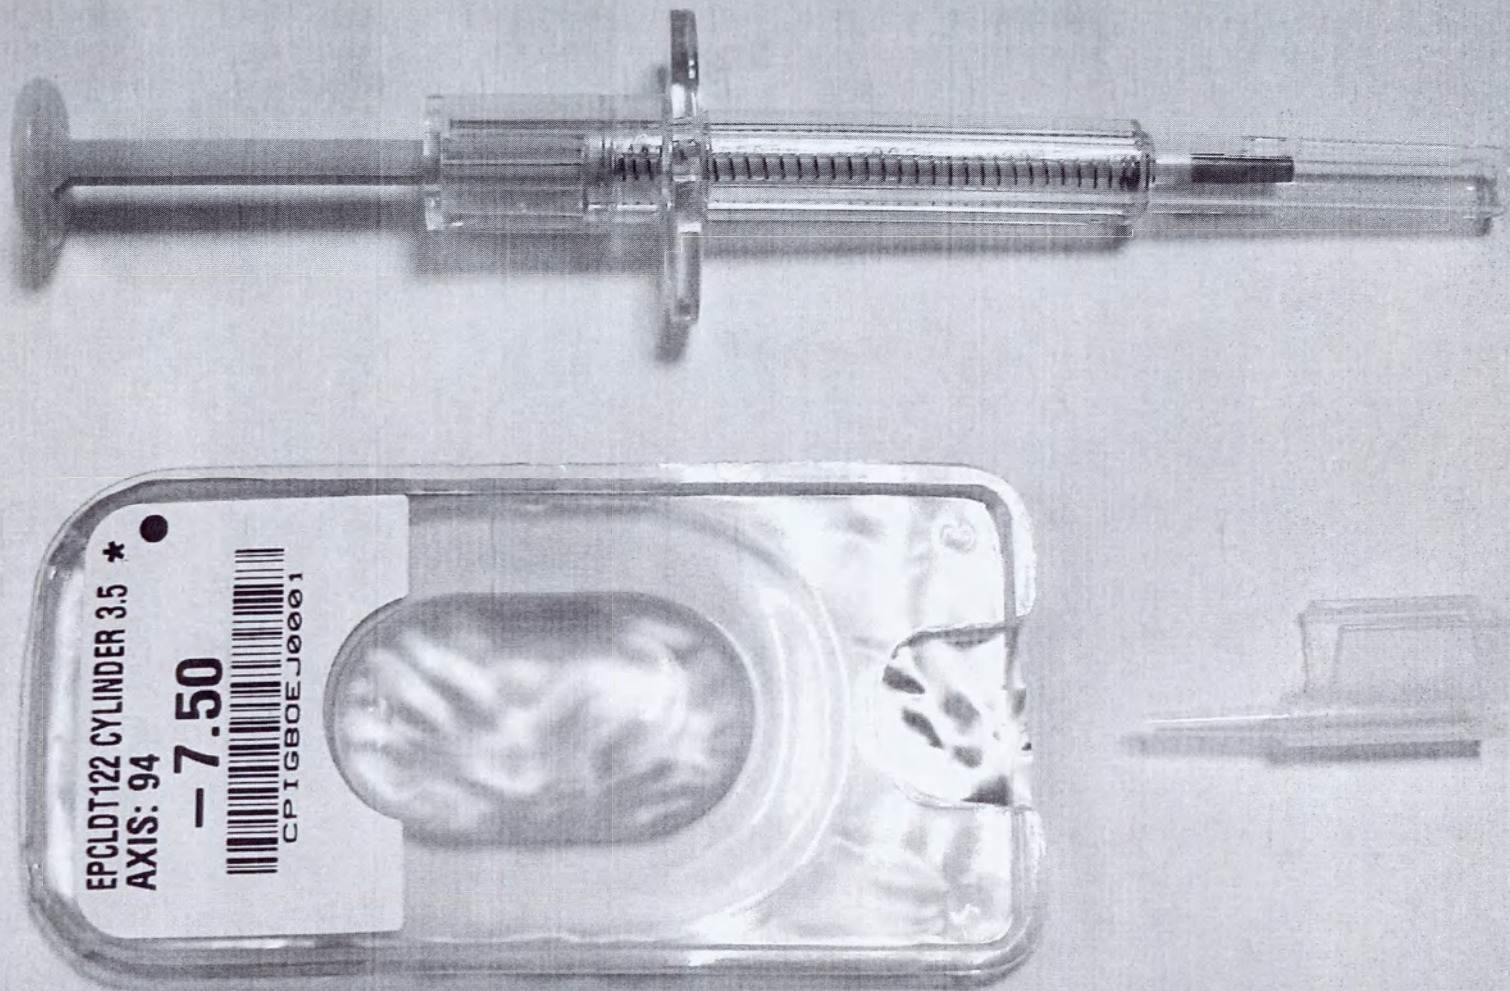

Линза интраокулярная факичная EyePCL Presbyopic Toric V2,0. Модель EPCLDT 122
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.

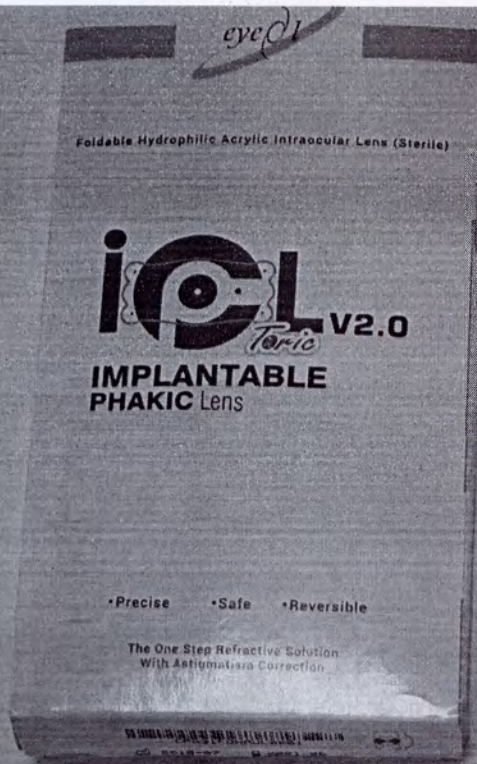

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж»
IPCL Toric V2.0

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» – однократное стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения- офтальмохирургия.

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001


STYLE: IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : IPCLT122 * CYLINDER 2.5
LENGTH :12.25 POWER : -16.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-06
CP631FDHML0001

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2.0. Модель IPCLT 122
Общий вид изделия

Rev. On: 09/2017

STYLE : IPCLT22 *CYLINDER 2.5
AXIS : 105
LENGTH : 12.25
A CONST: 0.0
LOT : CPG31
POWER : -16.50
OPT.DIA: 6.60



Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)



• Precise • Safe • Reversible

The One Step Refractive Solution
With Astigmatism Correction



2018-07 2021-06

Press
to tear

IMPLANTABLE
PHAKIC Lens




CPG31FDHML0001


- One sterile intraocular lens. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not re-sterilize.
- Eine sterile Intraokulare Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Sterilisieren Sie nicht wiederholt.
- Un seul intraoculaire à hydrogels. Avec filtre UV. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas re-stériliser.
- Ein sterile Intraokular Linse. Mit UV-Absorber. Använd inte om förpackningen är skadad. Må inte steriliseras om igen.
- Una lente intraocular estéril. Con filtro UV. No usar si el paquete está dañado. No re-esterilizar.
- Una lente intraocular sterile. Con filtro UV. Non usare se l'imballaggio è danneggiato. Non ri-sterilizzare.
- Uma lente intra-ocular estéril. Com filtro UV. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não volte a esterilizar.
- En sterile intra-ocular linse. Med UV filter. Må ikke bruges hvis emballeringen er beskadiget. Må ikke steriliseres igen.
- Een steriele intraoculaire lens. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet hersteriliseren.

Contents:
• One (1) Sterile (CPG31) Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens, Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
• Professional Information Leaflet.
• Patient Lens Implant Identification Card.
• Patient Record Labels.

Code: GUJ-DRUGS/G/28/1321
Eyeol UK Limited.
8 Apex Business Centre
Boscombe Road, Dunstable
Bedfordshire, LU5 4SB, UK
Tel: +44 (0) 1582 477 002
Fax: +44 (0) 1582 607 009
Email: info@eyeol.co.uk
Web: www.eyeol.co.uk





Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0 . Модель IPCLT.
Потребительская упаковка (коробка)

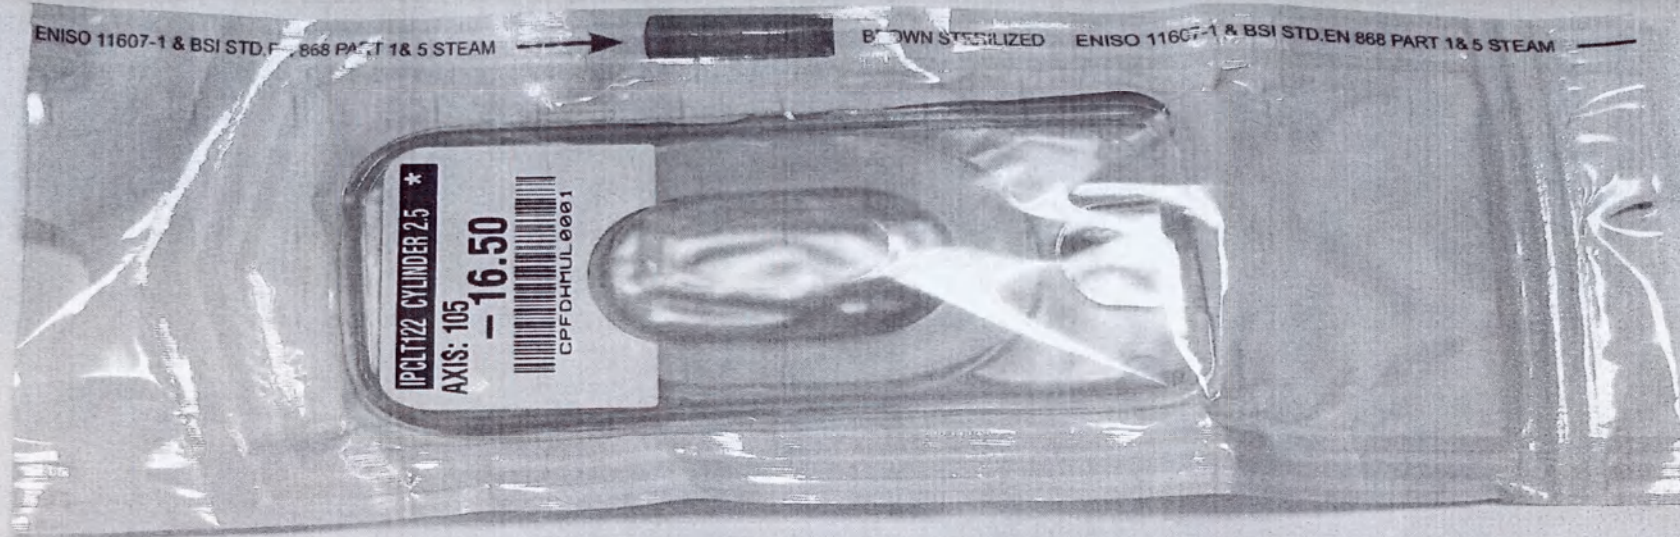

Foldable Intraocular Lens (Sterile)
STYLE : IPCLT122 *CYLINDER 2.5
POWER : -16.5 LOT:CPG3I
LENGTH : 12.25 :2018-07
OPT.DIA : 6.60 :2021-06
A.CONST : 0.0
EYEOL U.K. LIMITED
8 Apex Business Centre,
Boscombe Road, Dunstable,
Bedfordshire LU5 4SB, U.K.
Web: www.eyool.co.uk

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT 122.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

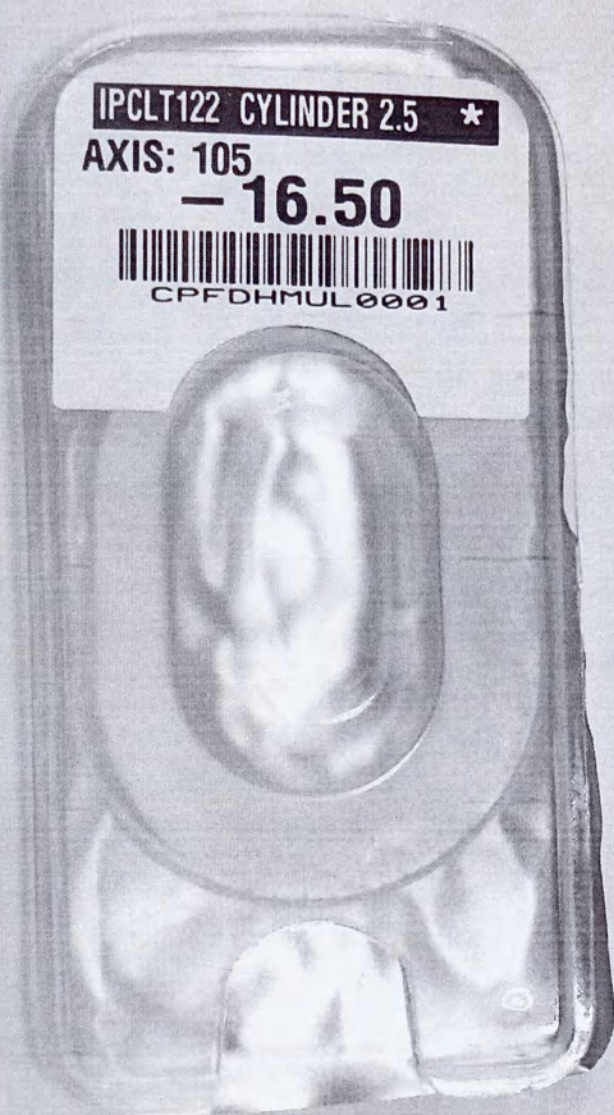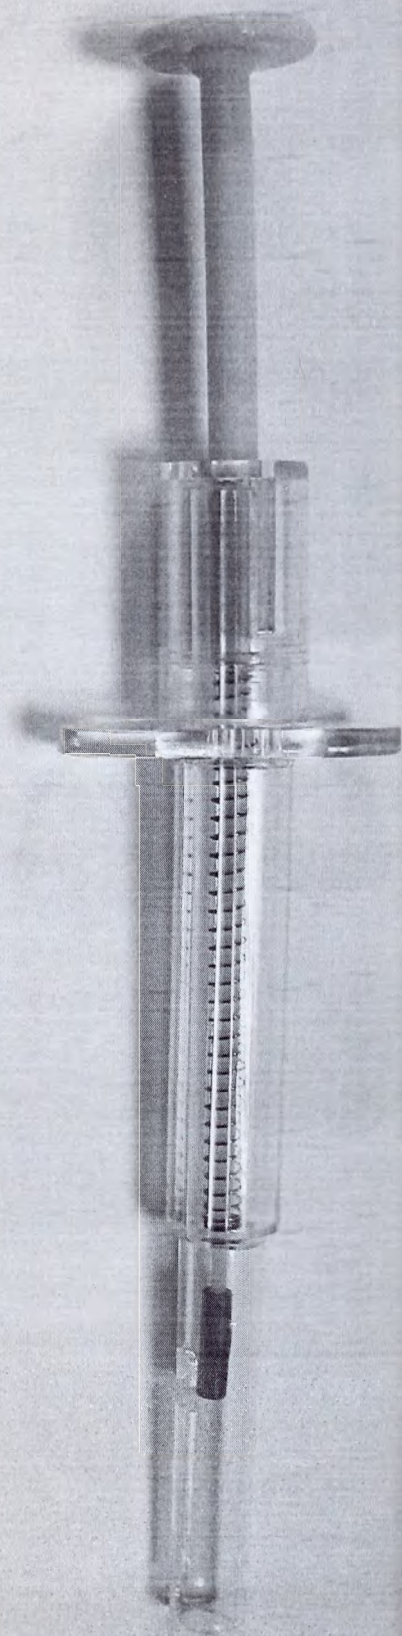

IPCLT122 CYLINDER 2.5 *



AXIS: 105

- 16.50



CPFDHML0001

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT 122.
Контейнер с линзой, инжектор и картридж.

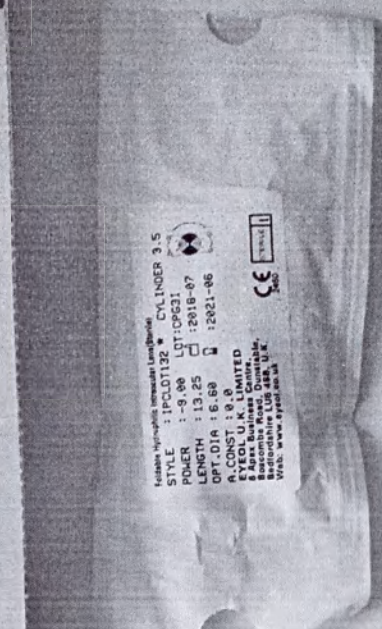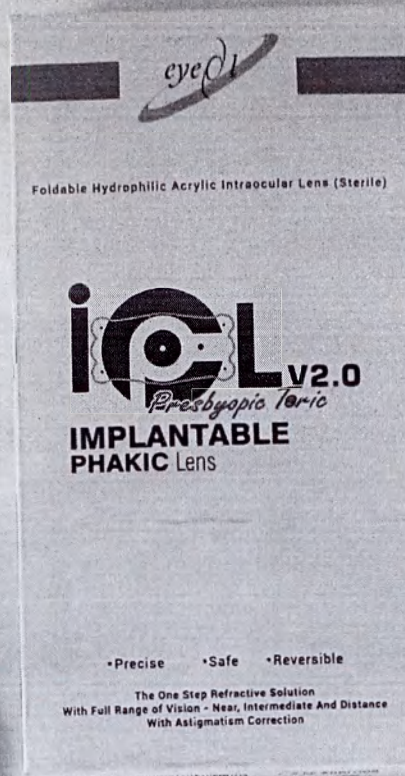

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

STYLE:IPCLDT132* CYLINDER 3.5
LENGTH :13.25 POWER :-9.00
OPT.DIA :6.60 Exp:2021-06

Patient's Name : _____

Implant Surgeon's Name : _____

Date of Surgery : _____

Implanted Eye : () R () L

STYLE :IPCLDT132* CYLINDER 3.5

LENGTH :13.25 POWER :-9.00

OPT.DIA: 6.60 Exp:2021-06

CPG31F1JNY10002

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» IPCL Presbyopic Toric V2.0

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» – одноразовое стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.


Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.


Область применения: офтальмохирургия.

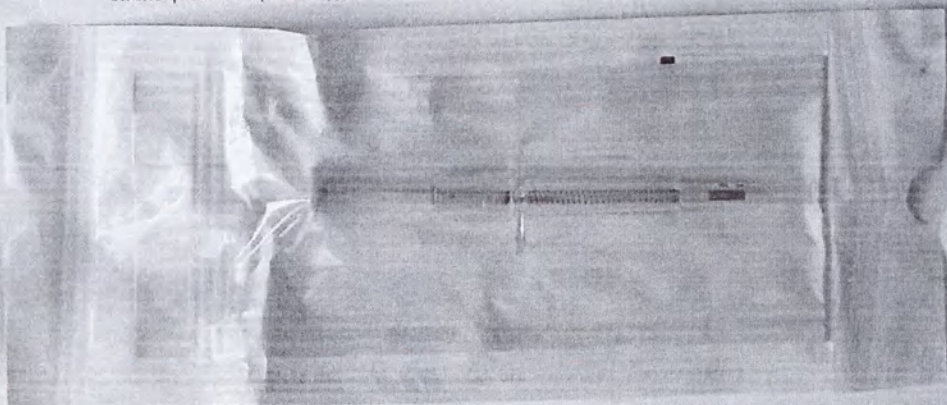

Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2,0 Модель IPCLDT 132. Общий вид изделия

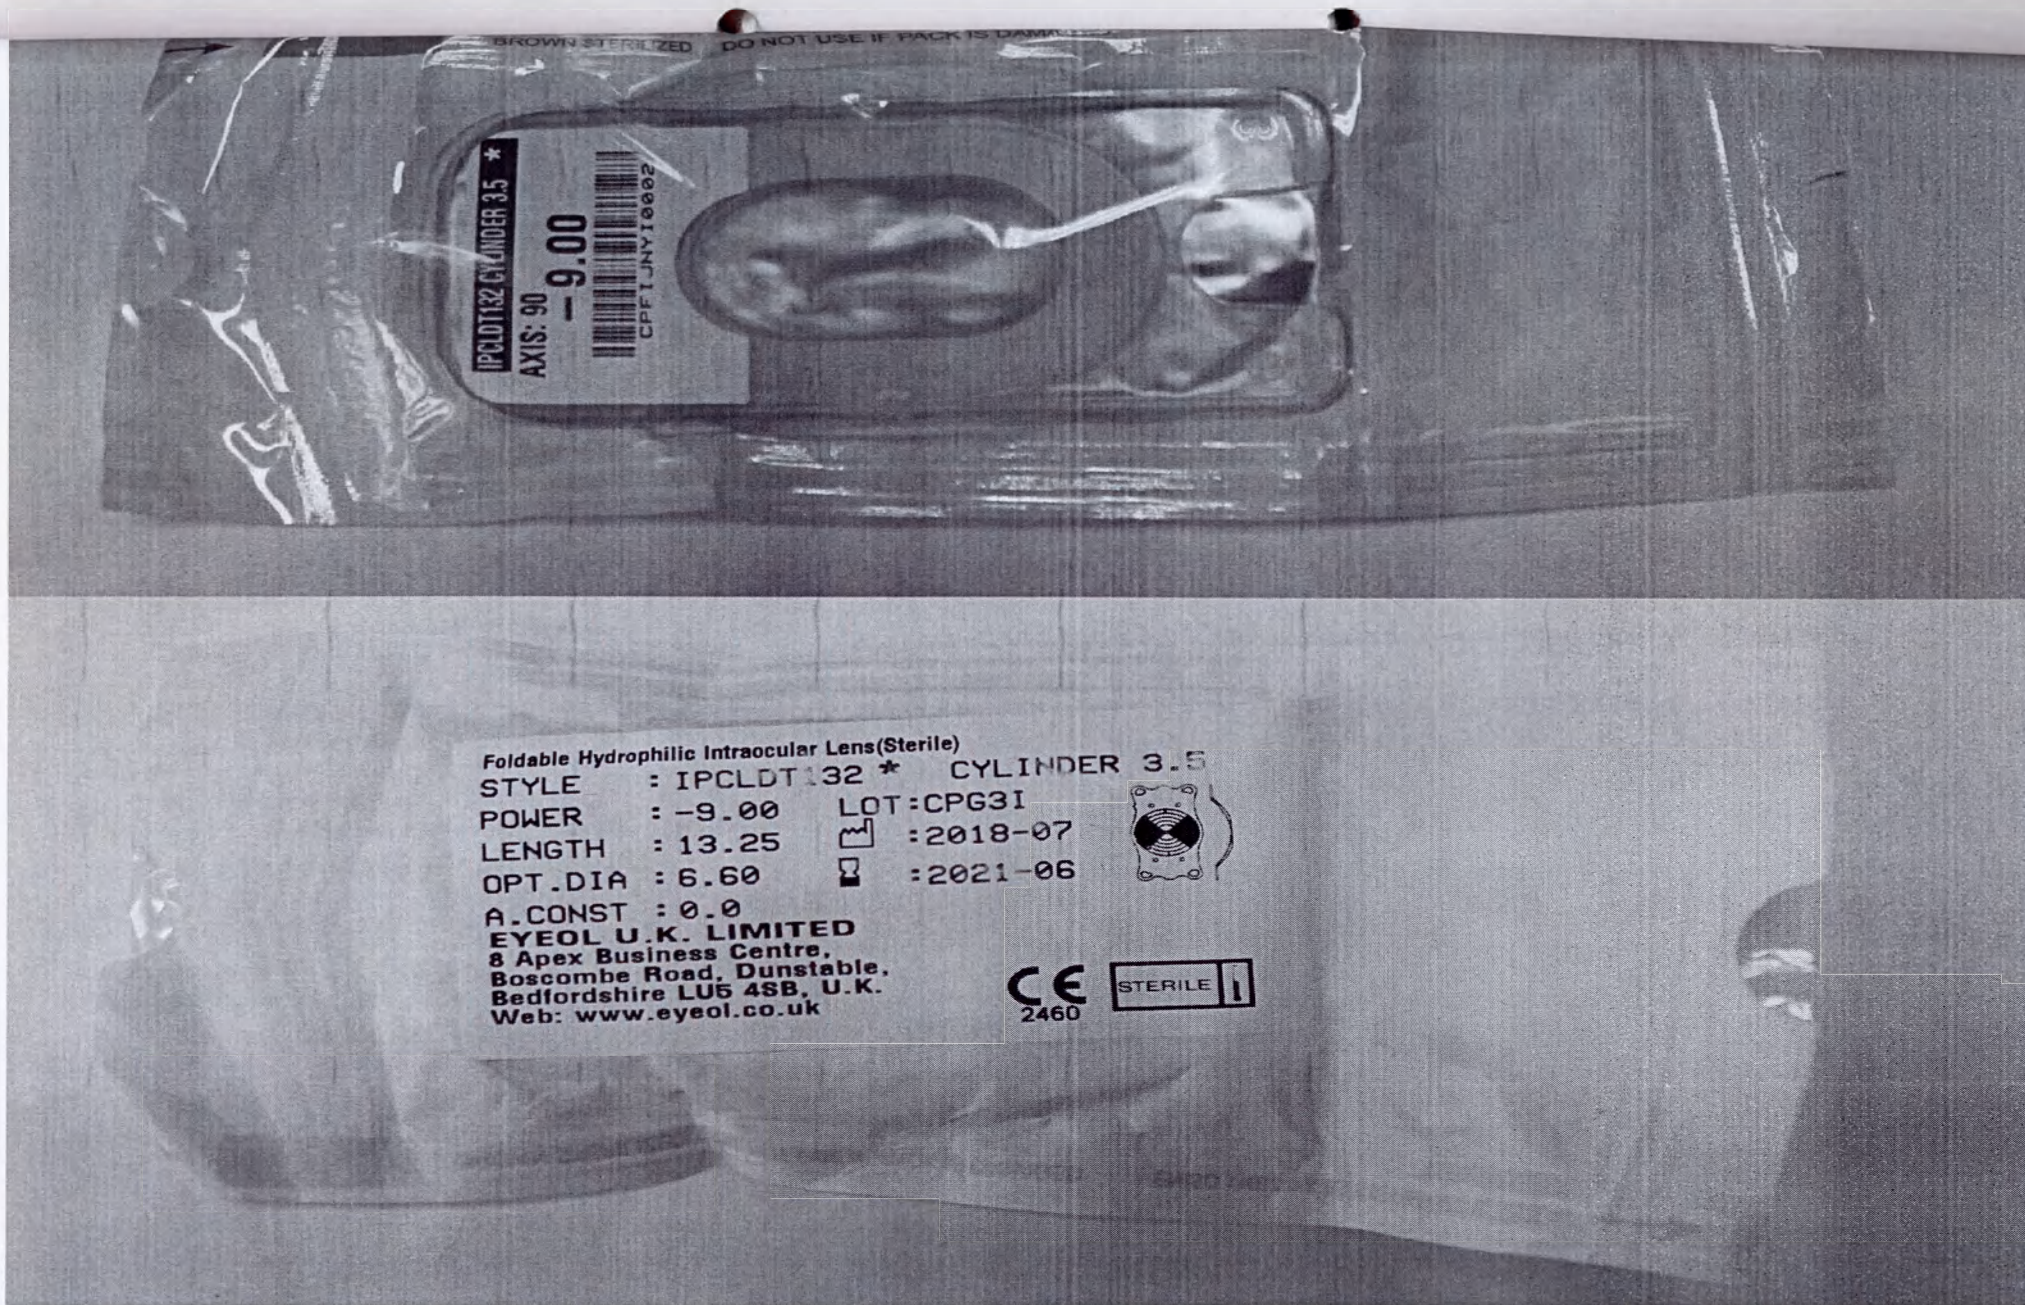


Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2,0. Модель IPCLDT 132
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

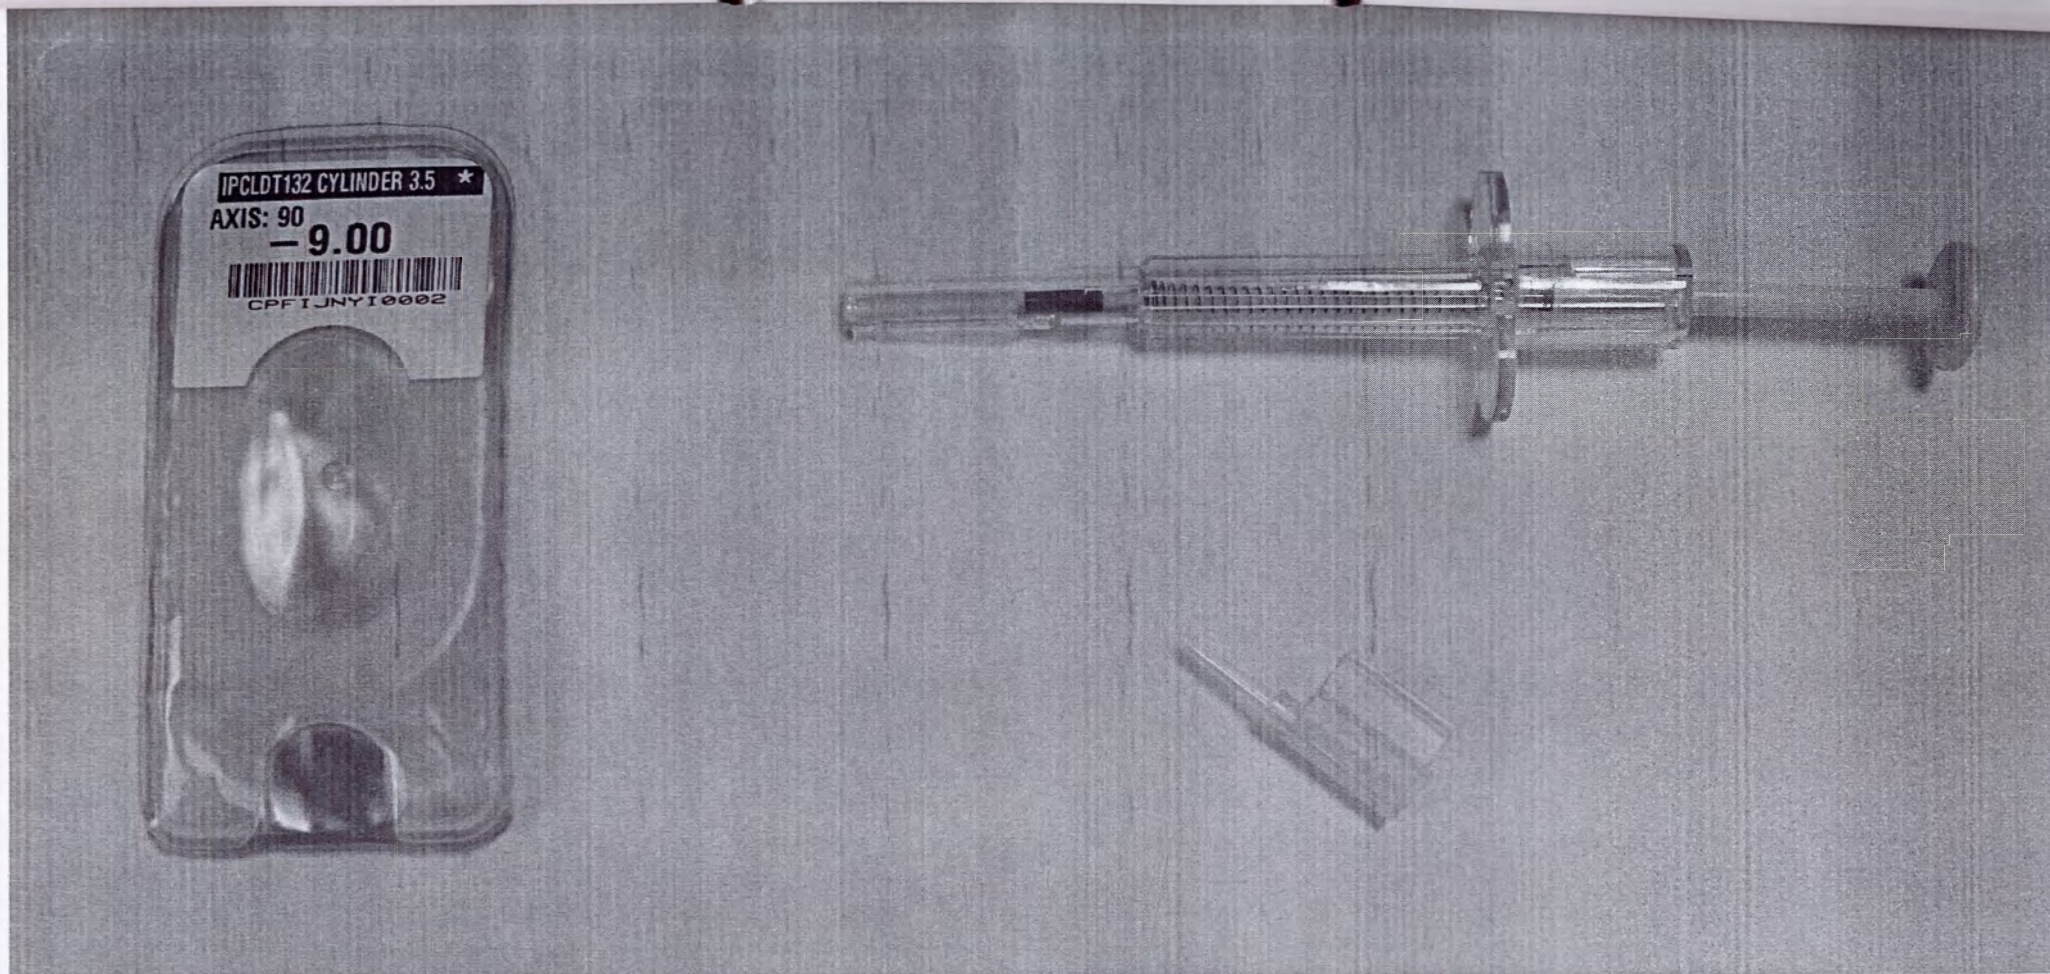


Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2,0. Модель IPCLDT 132
Контейнер с линзой, инжектор и картридж.

Фото блистерной упаковки для всех вариантов исполнения

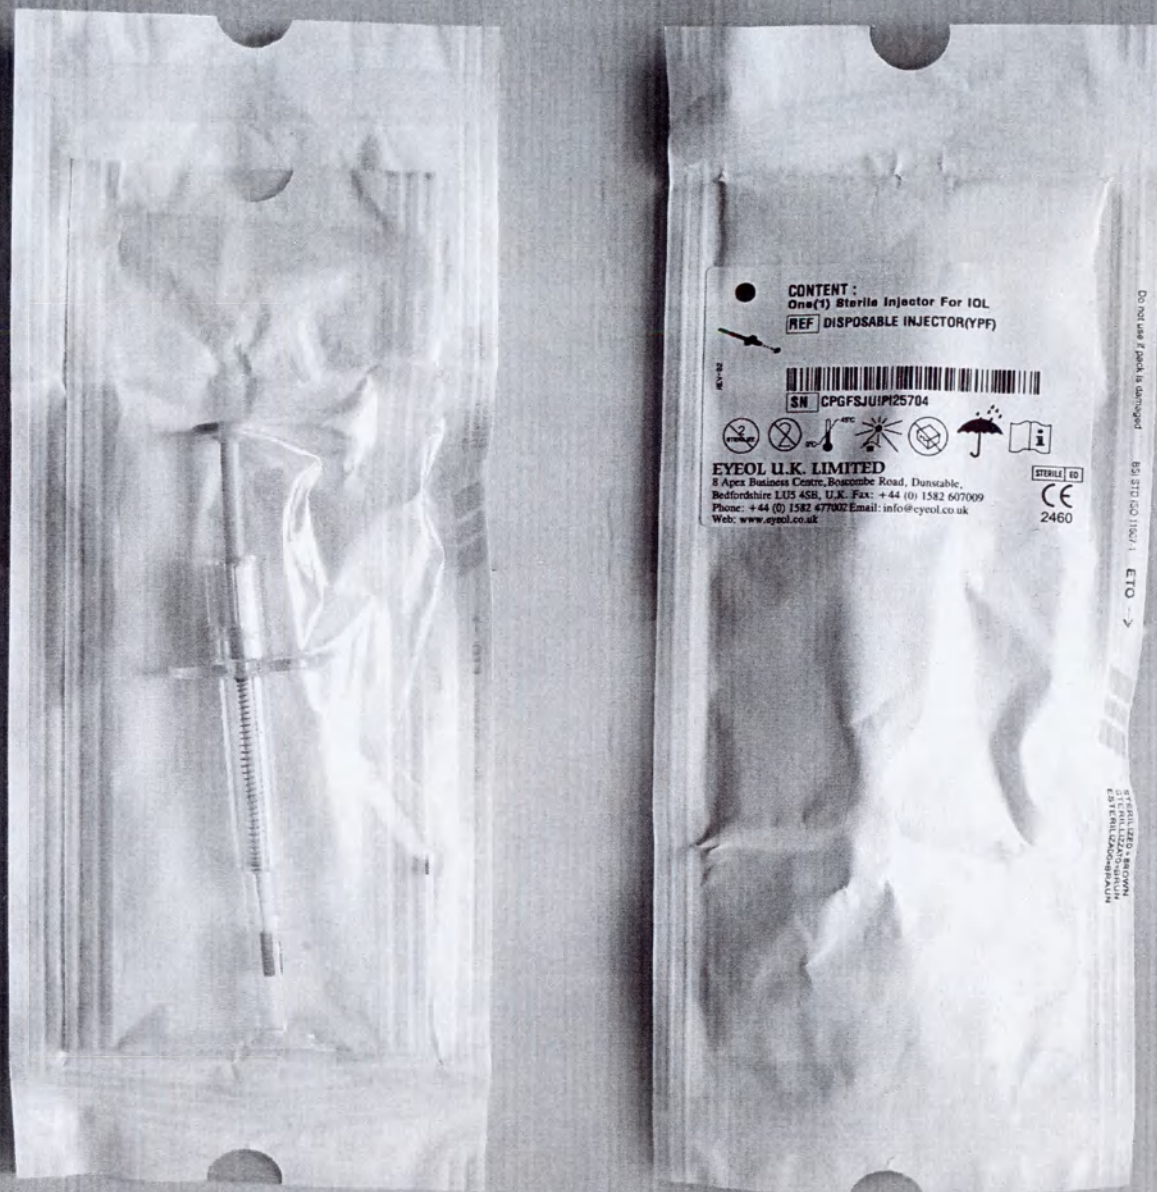

Инжектор. Индивидуальная упаковка (блистер)

Картридж. Индивидуальная упаковка (блистер)

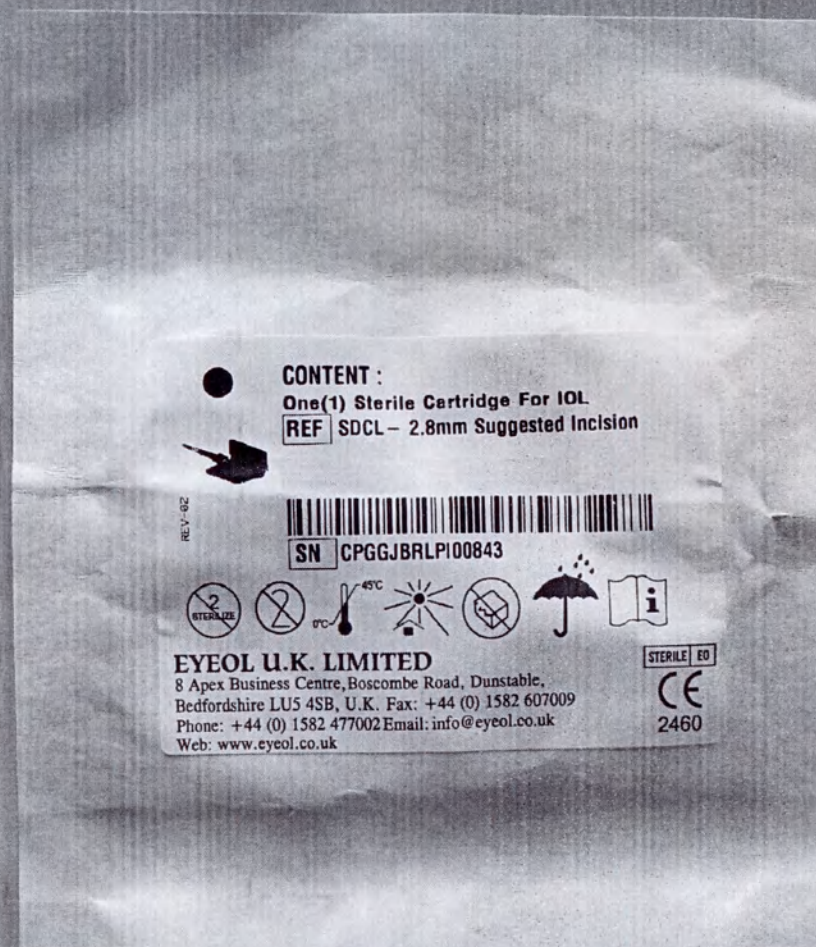

Присвоенный сертификат 0
испытания 36 месяцев



Перепроверка директор
Раван Д. Е. З.