

Фотографические изображения медицинского изделия



STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8
OPT.DIA :6.20

LENGTH :12.75 POWER :+8
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

LENGTH :12.75 POWER :+8
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

LENGTH :12.75 POWER :+8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+8.75
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :+9
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Eye : L R

STYLE :UAON127
LENGTH :12.75 POWER :+8
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факическая в составе линза, инжектор и картридж»
Sulcofix Add-on

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факическая в составе линза, инжектор и картридж» однократное стерильное изделие

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции псевдофакической глаукомы с применением имплантации (ИО) в капсульный мешок.

Медицинское изделие не должно использоваться в условиях стационарных медицинских учреждений, выполняющих медицинские услуги, медицинским персоналом, обученным технике и обработке медицинских изделий.

Медицинское изделие стерильно, не требует обработки.

Линза интраокулярная факическая Sulcofix Add-on. Модель UAON

Общий вид изделия

Комплект поставки:

Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on в контейнере в блистерной упаковке- 1 уп.

Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Наклейка пациента- 1 шт.

Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.

Инструкция по использованию- 1 шт.


Коробка - 1 шт.

STYLE : UAON
 LENGTH : 12.75
 A CONST : 0.0
 Exp Date : 2021-04
 LOT : CPH1A
 OPT.DIA : 6.20
 POWER : -8.50



Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

SulcoFix
 Add-on

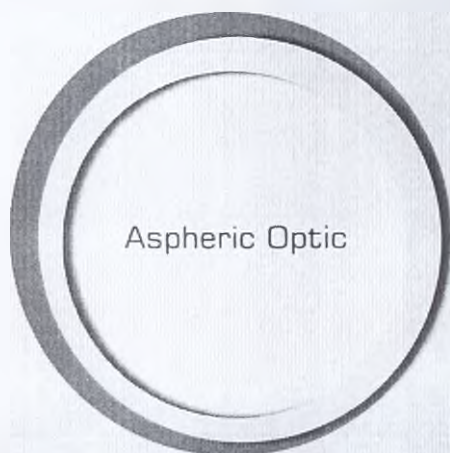

Aspheric Optic



CPH1A1KROA00005

2018-05 2021-04

CPH1A1KROA00005

Focus
 to tear



SulcoFix Add-on


One Sterile Intraocular Lens With UV Absorber. Do Not Use If The Packaging Is Damaged. Do Not Re-sterilize.
 Restriktieren:
 Eine Sterilisierte Intraokularlinse C X4. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Nicht wiedersterilisieren.
 Une Lentille Intraoculaire Avec Filtre UV. Ne Pas Utiliser Si L'emballage Est Endommagé. Ne Pas Resteriliser.
 Ein Steril Intraokuläre Linse Mit UV-absorbierender. Anwendung in der Verpackung ist beschädigt. Resterilisieren nicht.
 Uma Linse Intraocular Estéril Con Absorbedor De UV. No La Usar Si El Paquete Está Dañado. No Resterilizar.
 Uma Linse Intraocular Steril Con Filtro UV. Não Usar Se A Embalagem Estiver Danificada. Não Resterilizar.
 Uma lente intra-ocular filtro UV. Não a embalagem estiver danificada. Não reesterilizar.
 Ein Steril Intraokuläre Linse Mit UV Absorber. Bring Bitte, Wenn Emballagen Ist Beschädigt, Nae Resterilise.

Contents:

- One (1) Sterile (Pack) Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Lens) unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet.
- Patient Lens Implant Identification Card.
- Patient Record Labels.




Mfg. Lic. No.: G/28/1321
 Manufactured By:
 CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP
 Block No. 31/3CSE, Village Dabhase, Taluka - Padra,
 Dist. Vadodra - 391 440, Gujarat, India.
 customer@caregroupindia.com
 www.caregroupindia.com | www.caregroupopt.com



European Representative
 BIOVISION LIMITED



SulcoFix Add-on

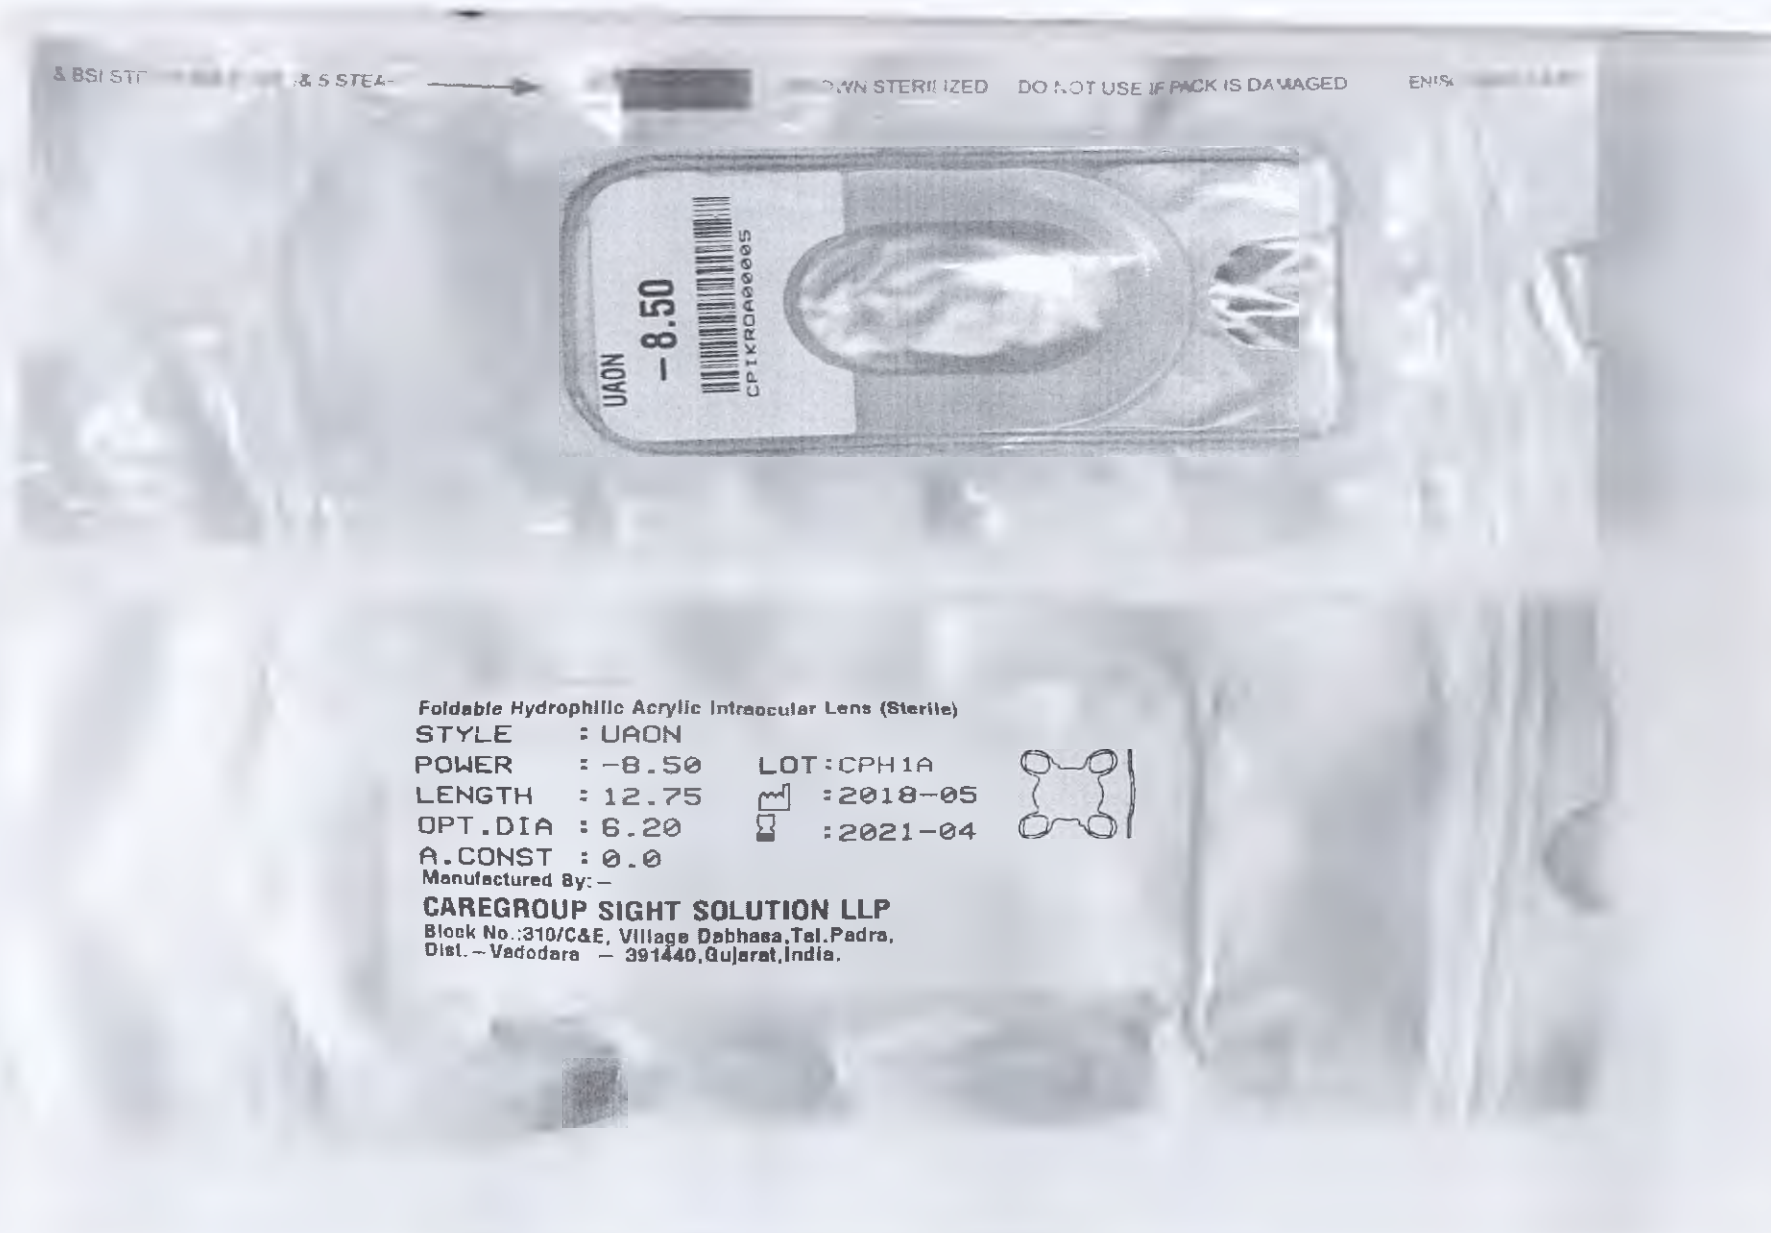

Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on. Модель UAON
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)



Линза интраокулярная факичная Sulcofix Add-on. Модель UAON
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.



CONTENT :

One(1) Sterile Cartridge For IOL

REF SDCL 1.85mm x 45°(N)
(2.8mm Suggested Incision)



SN CPGGJB71PI60363



By:
CareGroup Sight Solution LLP
Block No
Dist
www.caregroupof.com

EC REP European Representative
BIOVISION LIMITED

SRULX 20
CE

Картридж, блистерная упаковка



Инжектор, блистерная упаковка

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

STYLE:UAON
LENGTH :12.75 POWER :-8.50
OPT.DIA :6.20 Exp:2021-04


CPH1A1KROA000005

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : UAON127
LENGTH : 12.75 POWER : -8.50
OPT.DIA : 6.20 Exp:2021-04

CPH1A1KROA000005

Наклейка пациента

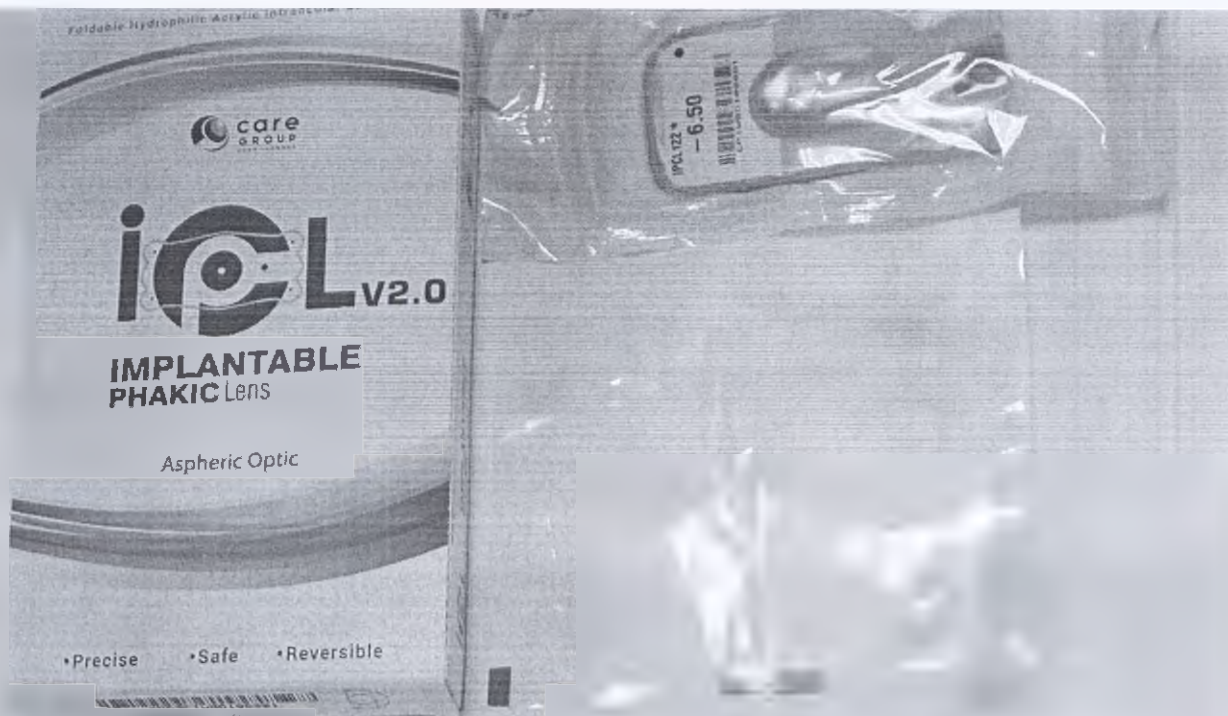

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж»
IPCL V2,0

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная факичная в составе: линза, инжектор и картридж» однократное стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения- офтальмохирургия.



Линза интраокулярная факичная IPCL V2,0. Модель IPCL122
Общий вид изделия

Комплект поставки:

Линза интраокулярная факичная IPCL V2,0 в контейнере в блистерной упаковке- 1 уп.

Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.



Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Наклейка пациента- 1 шт.

Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.

Инструкция по использованию- 1 шт.

Коробка - 1 шт.

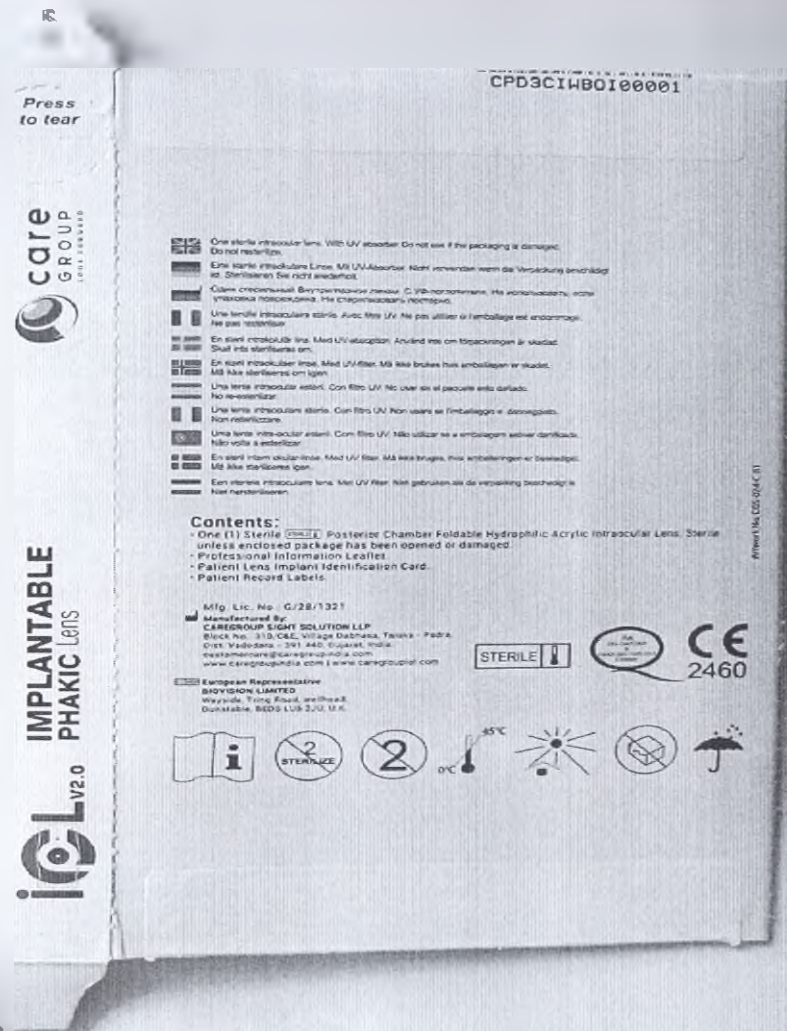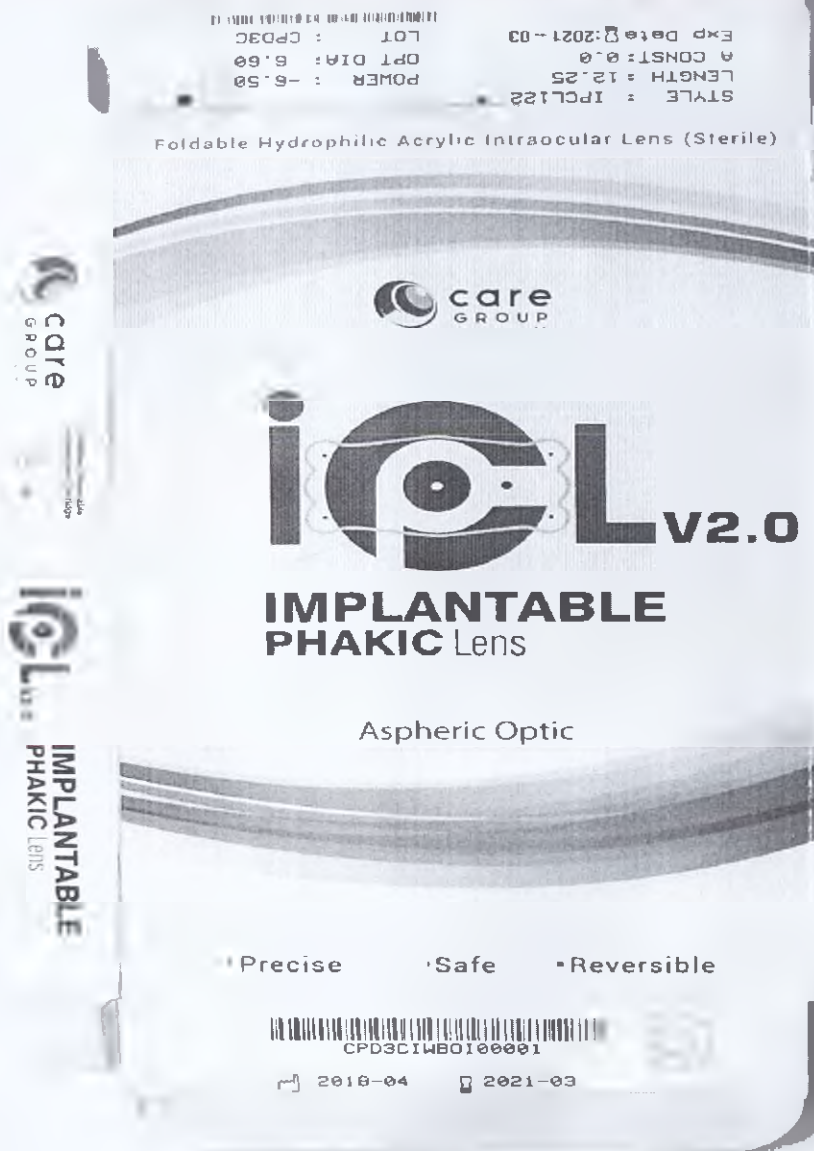

Линза интраокулярная факическая IPCL V2,0. Модель IPCL122
Потребительская упаковка (коробка)



Foldable Intraocular Lens (Sterile)

STYLE ■ IPCL122 ■

POWER : -6.50 LOT:CPD3C

LENGTH : 12.25  :2018-04

OPT.DIA : 6.60  :2021-03

A.CONST : 0.0


Manufactured By: -

CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP

Block No.:310/C&E, Village Dabhasa,Tal.Padra,
Dist. - Vadodara ~ 391440,Gujarat,India.




Линза интраокулярная факичная IPCL V2,0. Модель IPCL122
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

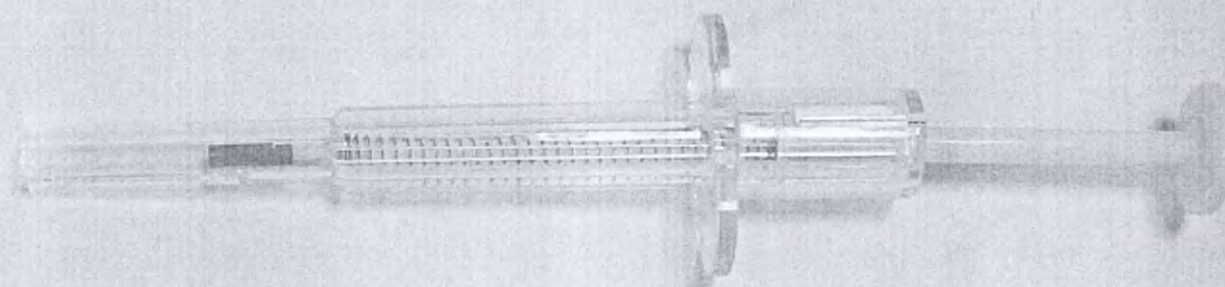

Линза интраокулярная факичная IPCL V2,0. Модель IPCL122
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.



Картридж, блистерная упаковка

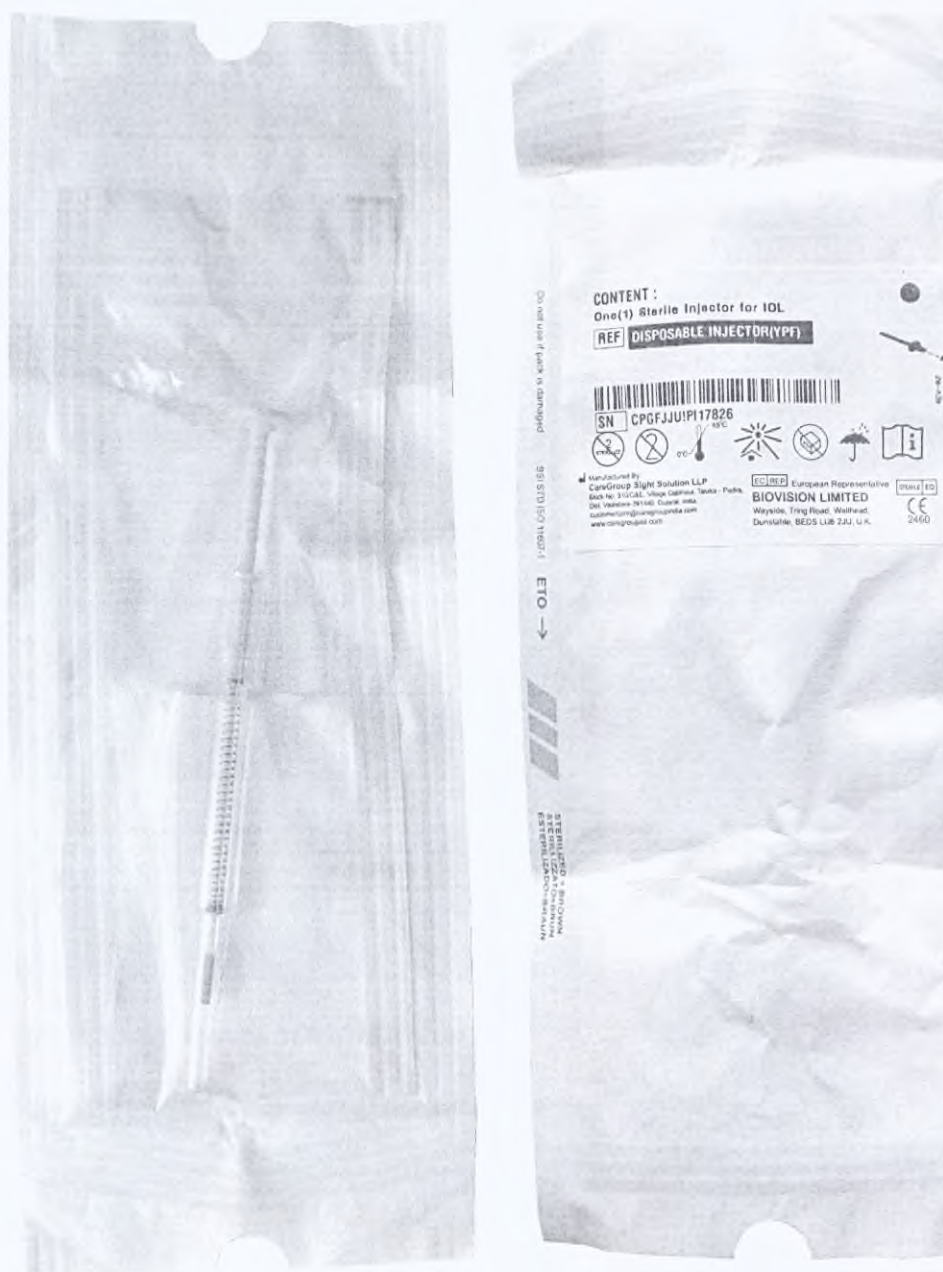

Инжектор, блистерная упаковка

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

STYLE:IPCL122 *
LENGTH :12.25 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

Наклейки контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : IPCL122 *
LENGTH : 12.25 POWER : -6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-03
CPD3C1H80100001

Наклейка пациента



ERIC L. Pridemore, Ph.D.

ՕՆԻԱԿԵ ԴՐՔԱԿԱՐԿԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒՄԻ ԶԵՆՈՒՄԸ



 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект поставки:

Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic V2,0 в контейнере в блистерной упаковке- 1 уп.

Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Наклейка пациента- 1 шт.

Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.

Инструкция по использованию- 1 шт.

Коробка - 1 шт.

STYLE : IPCLD13 * ADDITION 2.5
 LENGTH : 13.00
 A CONST: 0.0
 OPT.DIA: 6.60
 POWER : -6.00
 LOT : CPC02
 Exp Date: 2021-02

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)



IMPLANTABLE PHAKIC Lens

With Trifocal Vision

• Precise • Safe • Reversible



CPC0EFTACK00003

2018-03 2021-02

IMPLANTABLE PHAKIC Lens

CPC0EFTACK00003

English
 Russian
 Chinese
 Vietnamese
 Thai
 Indonesian
 Malay
 Tagalog
 Hindi
 Bengali
 Urdu
 Persian
 Arabic
 Hebrew
 Yiddish
 Korean
 Japanese
 Vietnamese
 Thai
 Indonesian
 Malay
 Tagalog
 Hindi
 Bengali
 Urdu
 Persian
 Arabic
 Hebrew
 Yiddish
 Korean
 Japanese

Contents:


- One (1) Sterile iOL Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens, Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet
- Patient Lens Implant Identification Card

Mfg. Lic. No. - G/28/1321

By
 CARE GROUP SIGHT SOLUTION LLP
 Block No. 216/CSC, Vijiya Nagar
 Anna Nagar - 600 095, Chennai - 600 095, India

European Representative
 Wayshis Trading Pte Ltd
 100, Upper Macao Road, Singapore 110001

STERILE



Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic V2,0. Модель IPCLD13. Потребительская упаковка (коробка)

Foldable Intraocular Lens (Sterile)
STYLE : IPCLD13 * ADDITION 2.5
POWER : -6.00 LOT: CPC0E
LENGTH : 13.00 : 2018-03
OPT. DIA : 6.60 : 2021-02
A. CONST : 0.0
Manufactured By: -
CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP
Block No.: 316/C&E, Village Dabhosa, Tal. Padra,
Dist. - Vadodra - 391440, Gujarat, India.



Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic V2,0. Модель IPCLD13.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)


IPCLD13 ADDITION 2.5 *

- 6.00



CPFTAOK00003

**Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic V2,0. Модель IPCLD13.
Контейнер с линзой , инжектор и картридж**

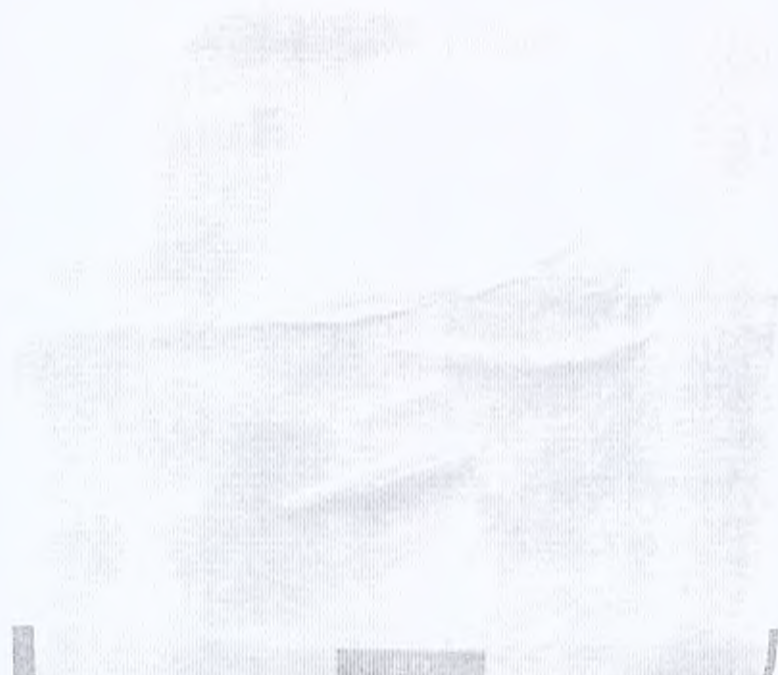

CONTENT :

One(1) Sterile Cartridge For IOL

REF SDCL 185mm x 45°(N)
(2.5mm Spherical Includer)



SN CPGGJB7!PI60363



Manufactured By:
CareGroup Sight Solution LLP
Block No. 210/Cat., Village Chutkora, Tinsukia - P.O.,
Dist. Jorhat-781145, Assam, India
customerservice@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com

EC REP European Representative
BIOVISION LIMITED
Wayde, Tring Road, Welham,
Dunstable, BEDS LU6 7JU, U.K.



Картридж, блистерная упаковка

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

STYLE:IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH :13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

Наклейки контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : IPCLD13 * ADDITION 2.5
LENGTH : 13.00 POWER :-6.00
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-02
CPC0EFTACK000003

Наклейка пациента

Комплект поставки:

Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2,0 в контейнере в блистерной упаковке- 1 уп.

Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Наклейка пациента- 1 шт.

Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.

Инструкция по использованию- 1 шт.

Коробка - 1 шт.



Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2,0.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)



Линза интраокулярная факичная IPCL Presbyopic Toric V2.0. Модель IPCLDT127
Контейнер с линзой , инжектор и картридж.



CONTENT :

One(1) Sterile Cartridge For IOL

REF SDCL 1185mm x 45°(N)
(2.5mm Suggested Incision)



SN CPGGJB71PI60363



Manufactured By:
CareGroup Sight Solution LLP
Block No. 310 Cat. Village Dushkha, Tanka - Pindra,
Dist. Vadodra-391040, Gujarat, India
customercare@caregroupspl.com
www.caregroupsl.com

EC REP European Representative
BIOVISION LIMITED
Wayside, Tring Road, Welstead,
Dunstable, BEDS LU6 2JU, U.K.

STERILE
EO
CE
2460

Картридж, блистерная упаковка

Инжектор, блистерная упаковка



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12




STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12




STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12



STYLE:IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH :12.75 POWER :-4.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2020-12





Наклейки контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : IPCLDT127 * CYLINDER 0.5
LENGTH : 12.75 POWER : -4.50
OPT.DIA: 6.60 Exp:2020-12



Наклейка пациента

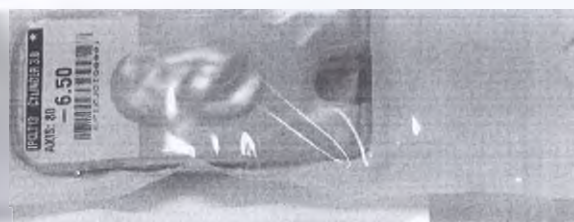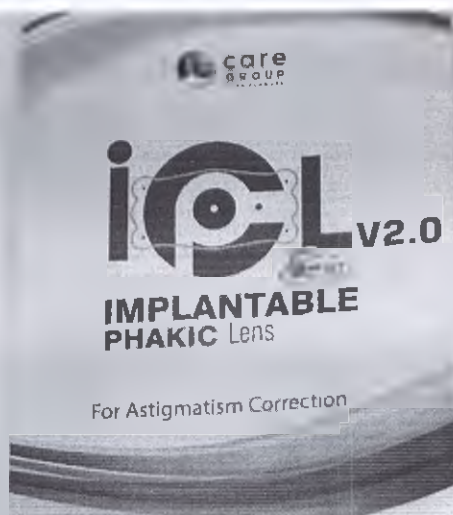

•Precise •Safe •Reversible

Инструкция по применению медицинского изделия
интраокулярная факическая в составе: линза, инъектор и картридж
IPCL Toric V2,0

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» в составе: линза, инъектор и картридж – одноразовое стерильное изделие.

Медицинское изделие предназначено для коррекции рефракции естественного хрусталика глаза человека.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием.

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.

Область применения- офтальмохирургия.

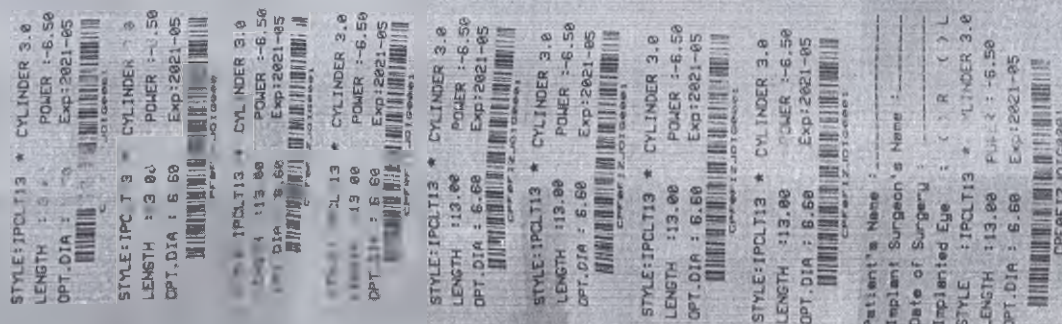

Линза интраокулярная факическая IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT13.
Общий вид изделия

Комплект поставки:

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0 в контейнере в блистерной упаковке- 1 уп.

Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.


Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Наклейка пациента- 1 шт.

Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.

Инструкция по использованию- 1 шт.

Коробка - 1 шт.

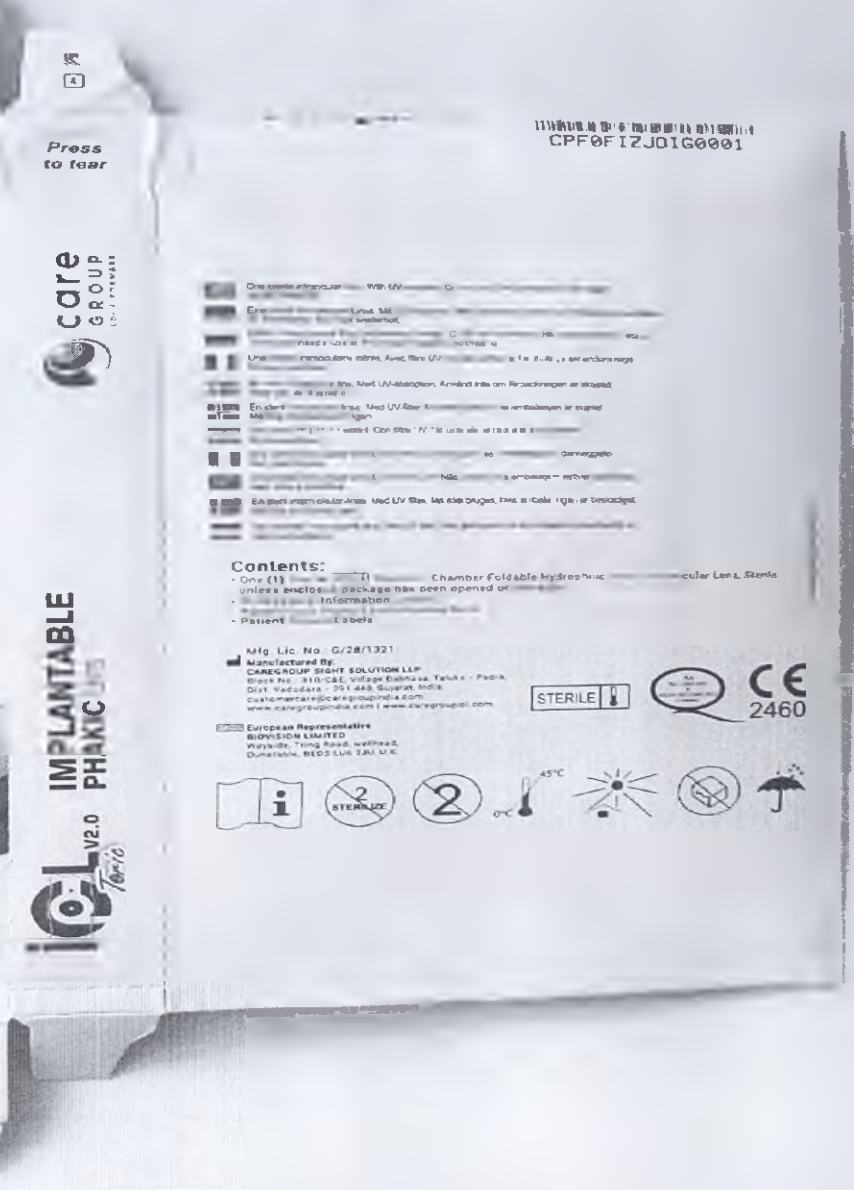

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT13.
Потребительская упаковка (коробка)

LIDED DO NOT USE IF PACK IS DAMAGED ENISO 1107-1 & BSI STD EN1868 PART 1.5 STEAM



Foldable Intraocular Lens (Sterile)

STYLE : IPCLT13 * CYLINDER 3.0

POWER : -6.50 LOT: CPF0F

LENGTH : 13.00 2018-06

OPT.DIA : 6.60 2021-05

A.CONST : 0.0

Manufactured By: -

CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP

Block No.: 310/C&E, Village Dabhaha, Tal. Padra,

Dist. - Vadodra - 391440, Gujarat, India



STERILE

Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT13, контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)



Линза интраокулярная факичная IPCL Toric V2,0. Модель IPCLT13.
Линза в контейнере, инжектор, картридж.



CONTENT :

One(1) Sterile Cartridge For IOL

REF SDCL 1.85mm x 45°(N)
(2.8mm Suggested Incision)



SN | CPGGJB71PI60363



Manufactured by
CaroGroup Sight Solution LLP
Block No. 310056 Village (Jambasa,
Dist. ...
customer@carogroupindia.com
www.carogroupindia.com

EC REP European Representative
BIOVISION LIMITED
Waycote, Tring Road, Welham,
Dunstable, BEDS LU6 2JU, U.K.

medeo
200

Картридж, блистерная упаковка



Инжектор, блистерная упаковка

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH : 13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

STYLE:IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER :-6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : IPCLT13 * CYLINDER 3.0
LENGTH :13.00 POWER : 6.50
OPT.DIA : 6.60 Exp:2021-05
CPFF0F12J01G0001

Наклейка пациента

Исполнено и сдано
первое издание
Тен. Сидорова
Работы

