

**«Средства для реабилитации: костыли
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018»**

Фотографические изображения

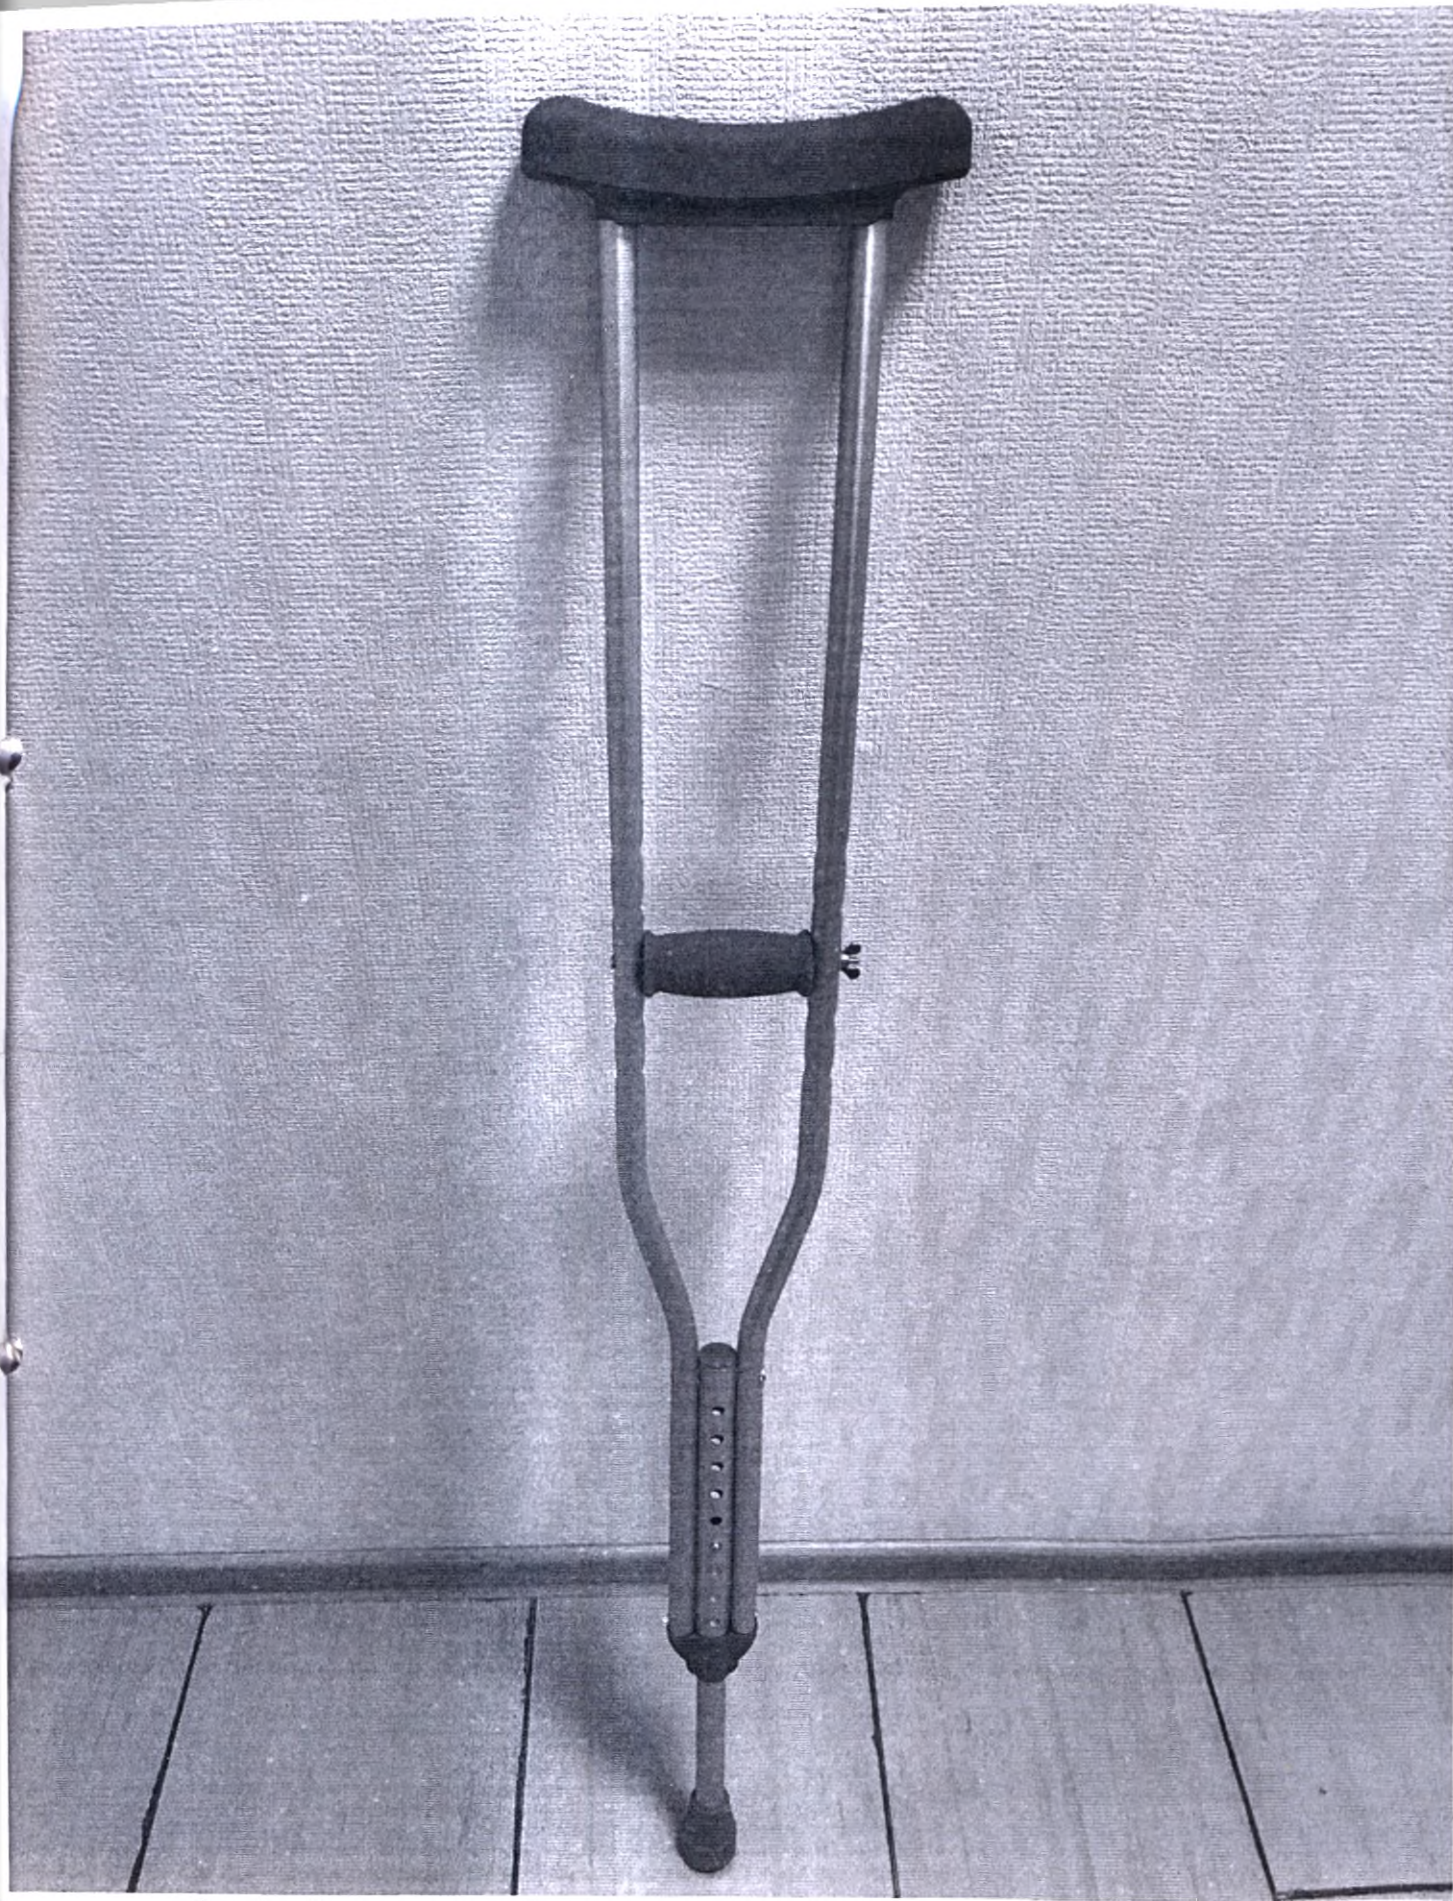
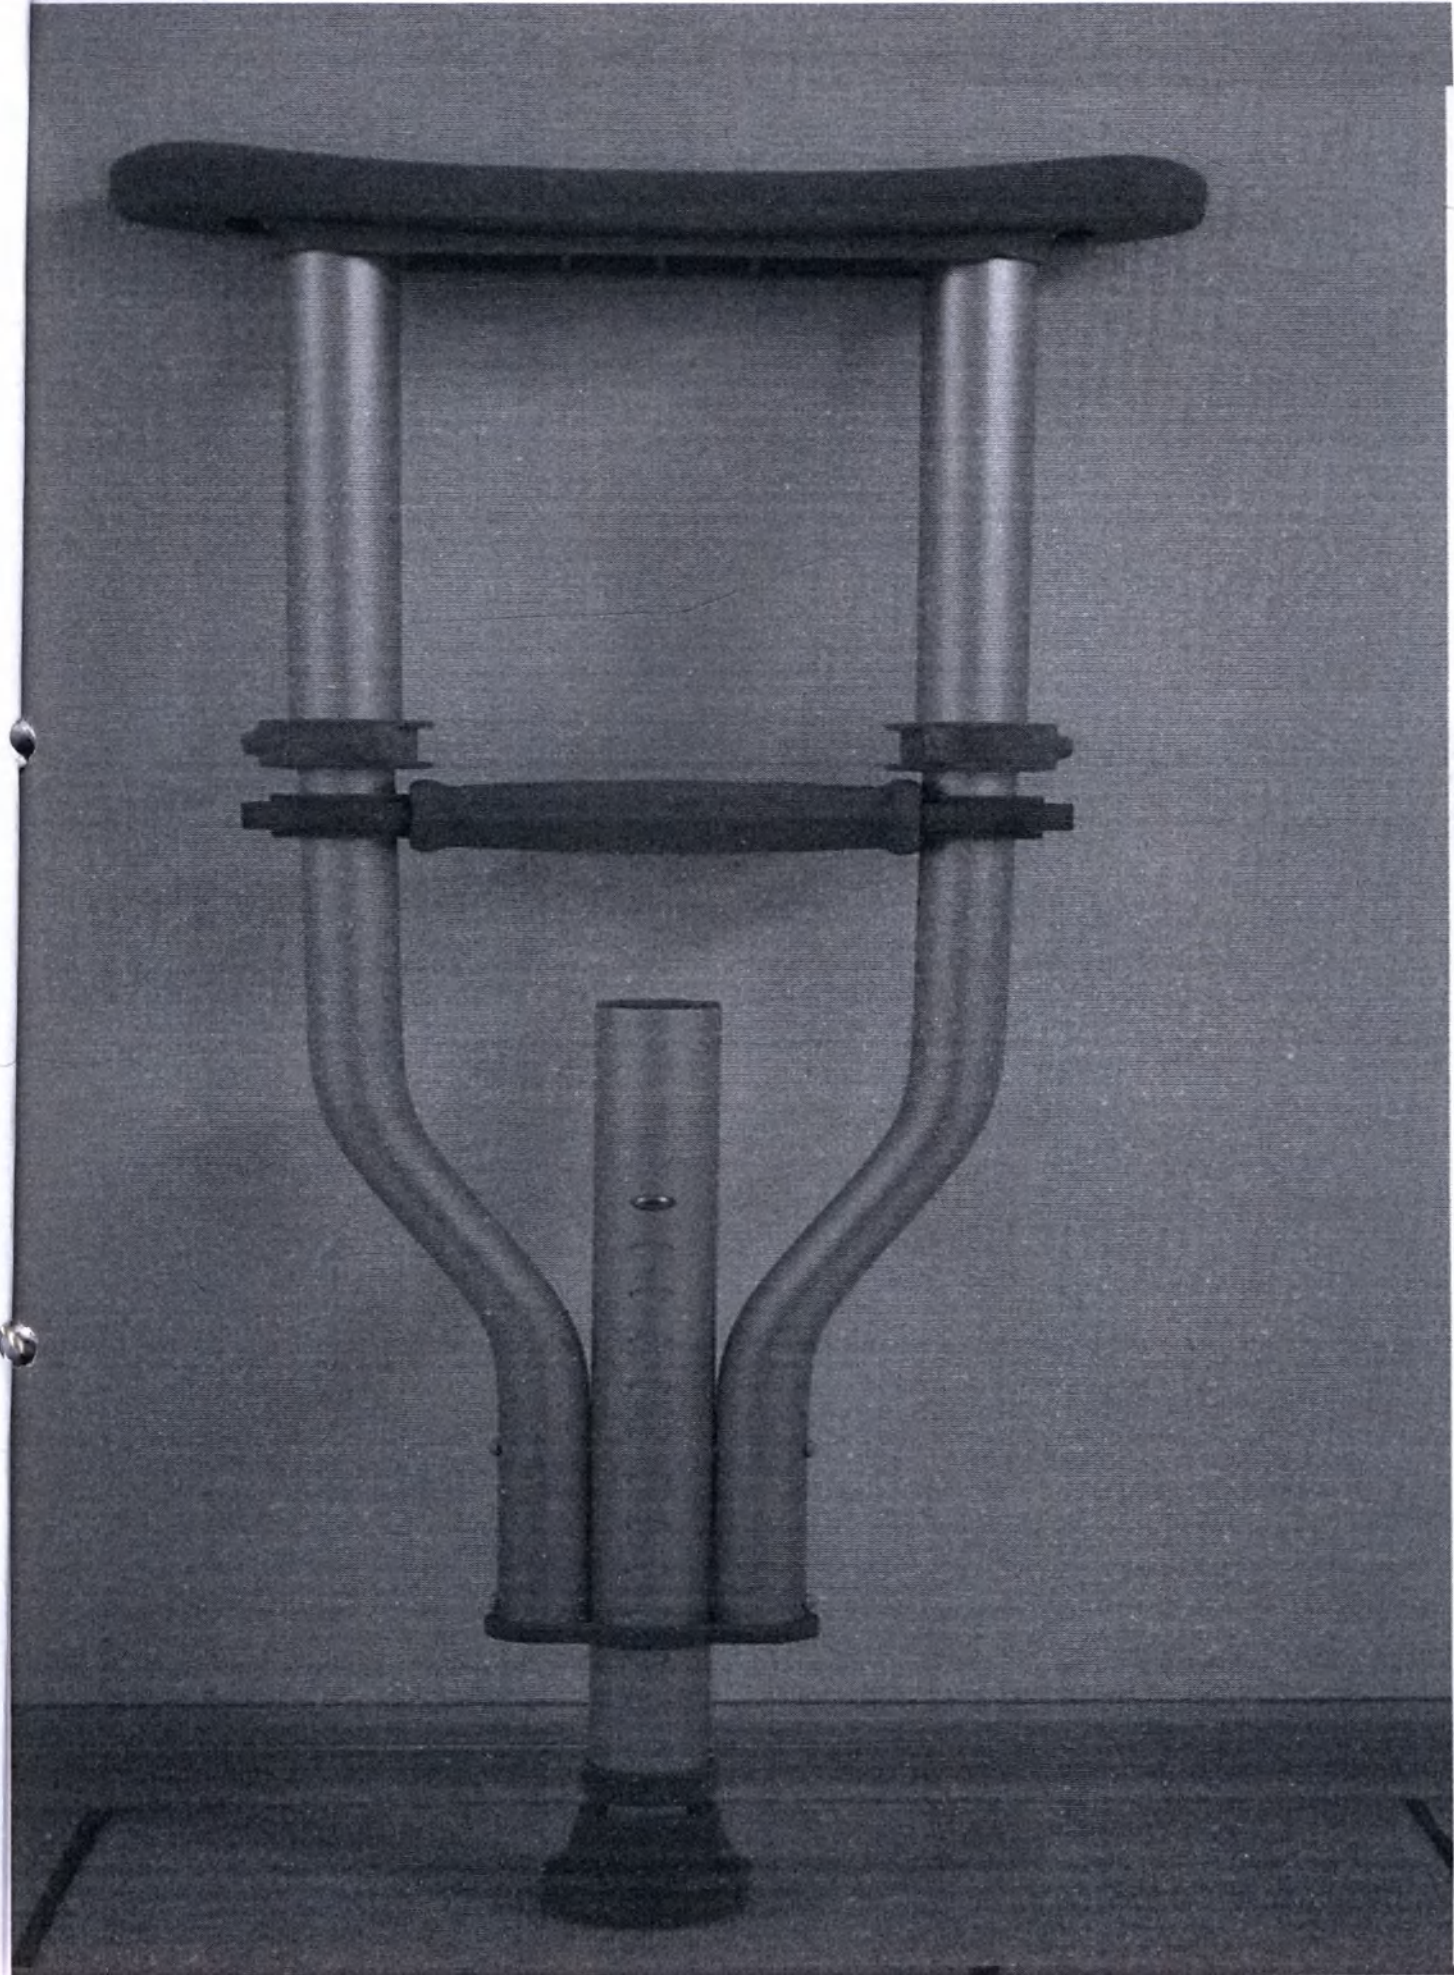


Рис. 1 – Средства для реабилитации: костыль подмышечный, модель Т.Р200
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018



**Рис.2 – Средства для реабилитации: костыль подмышечный, модель Т.Р210
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018**

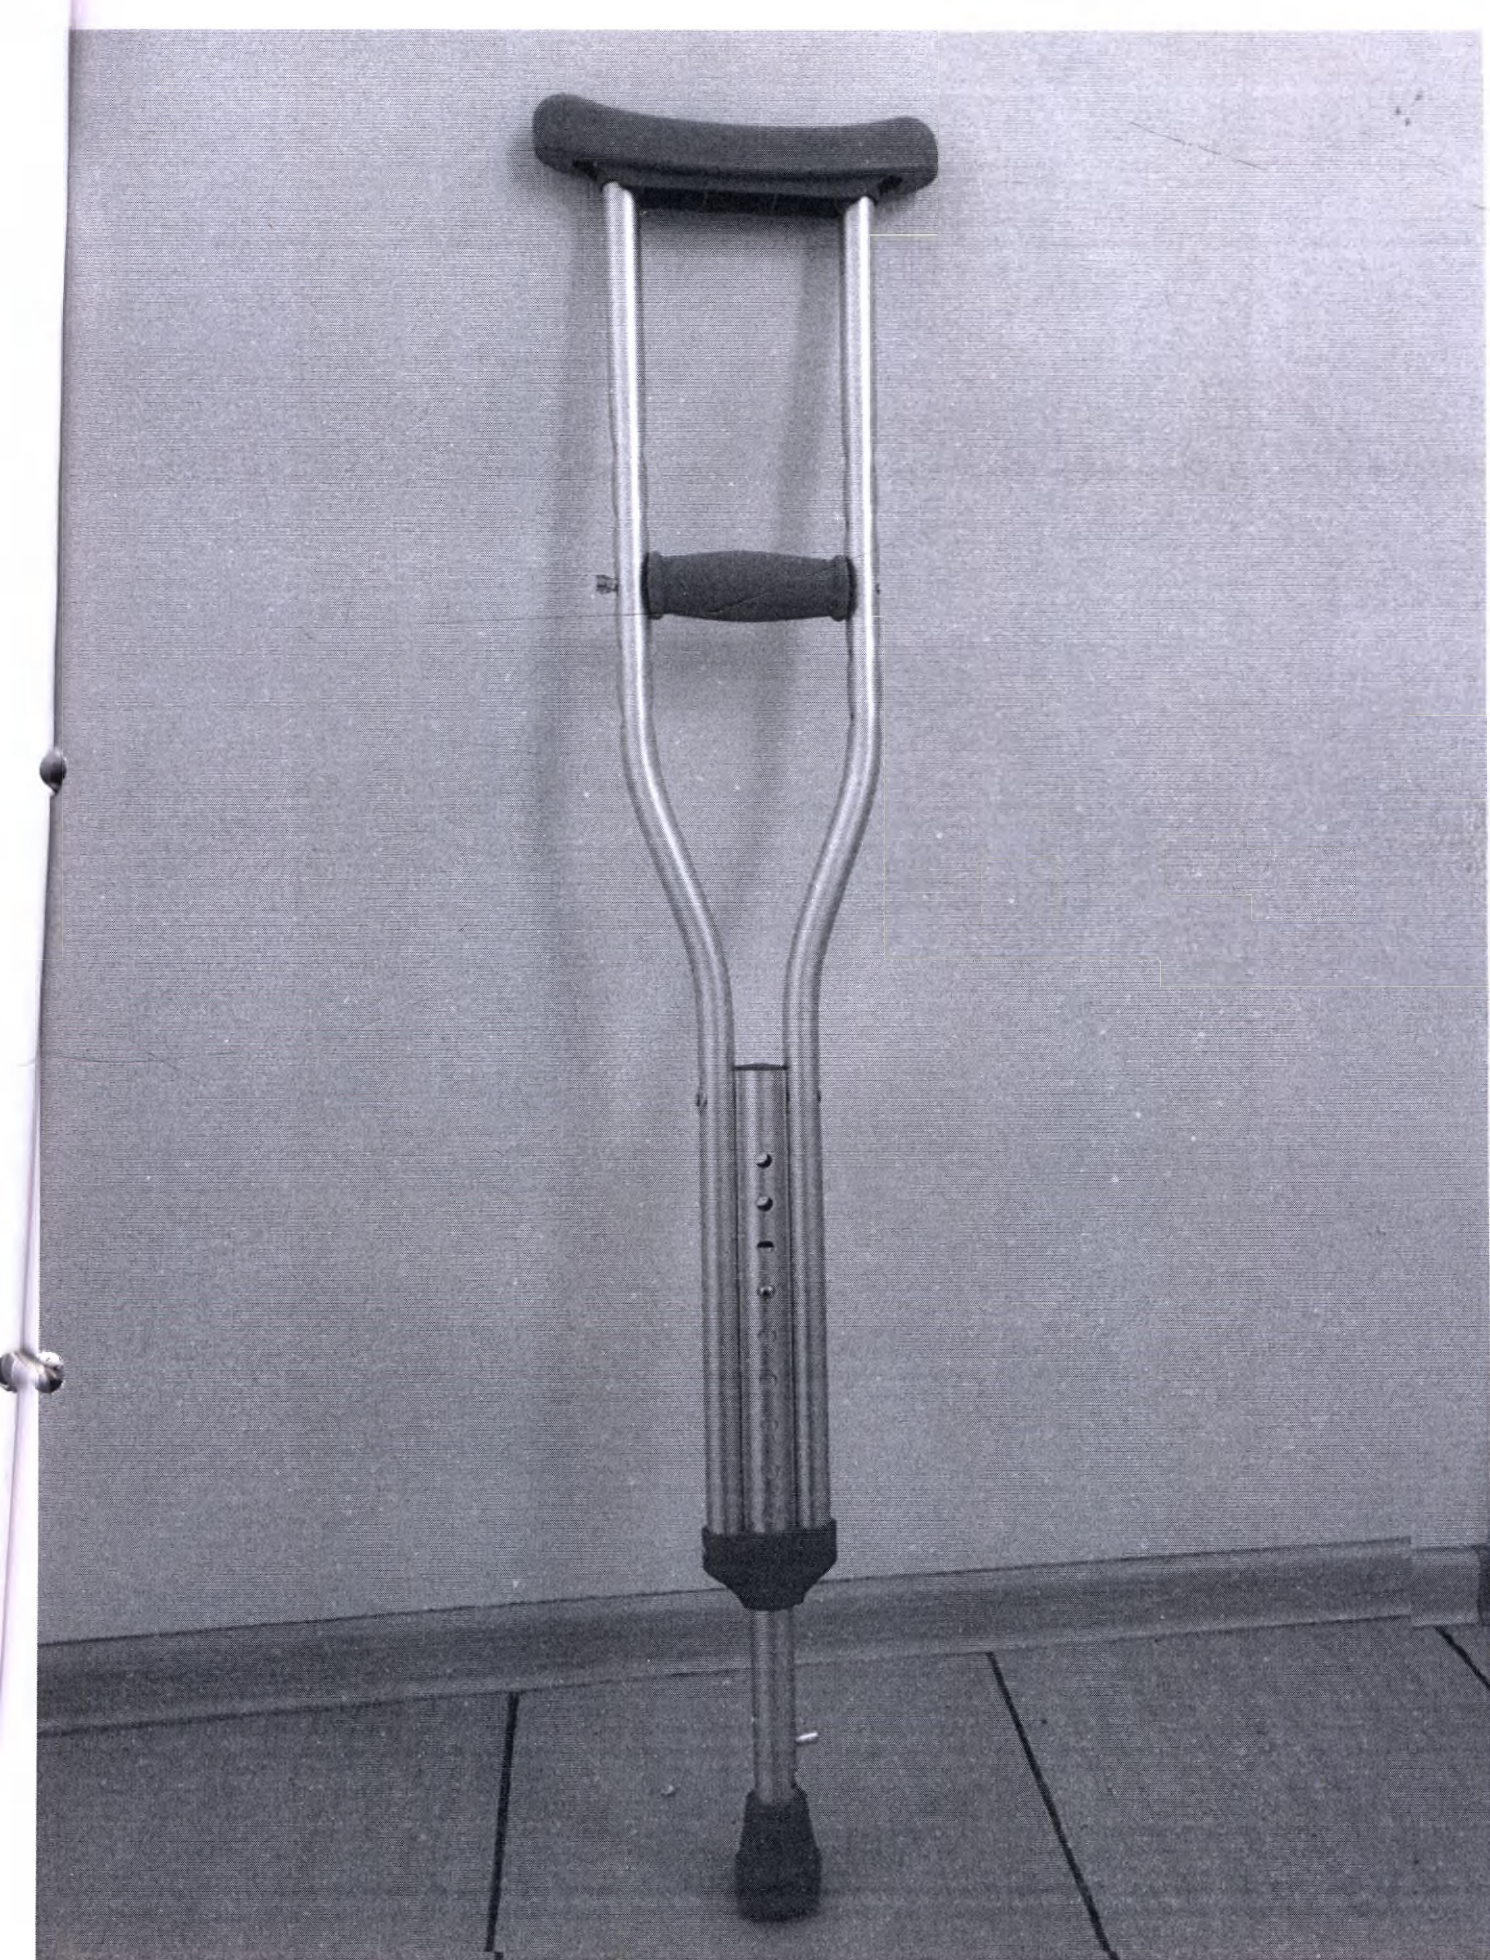
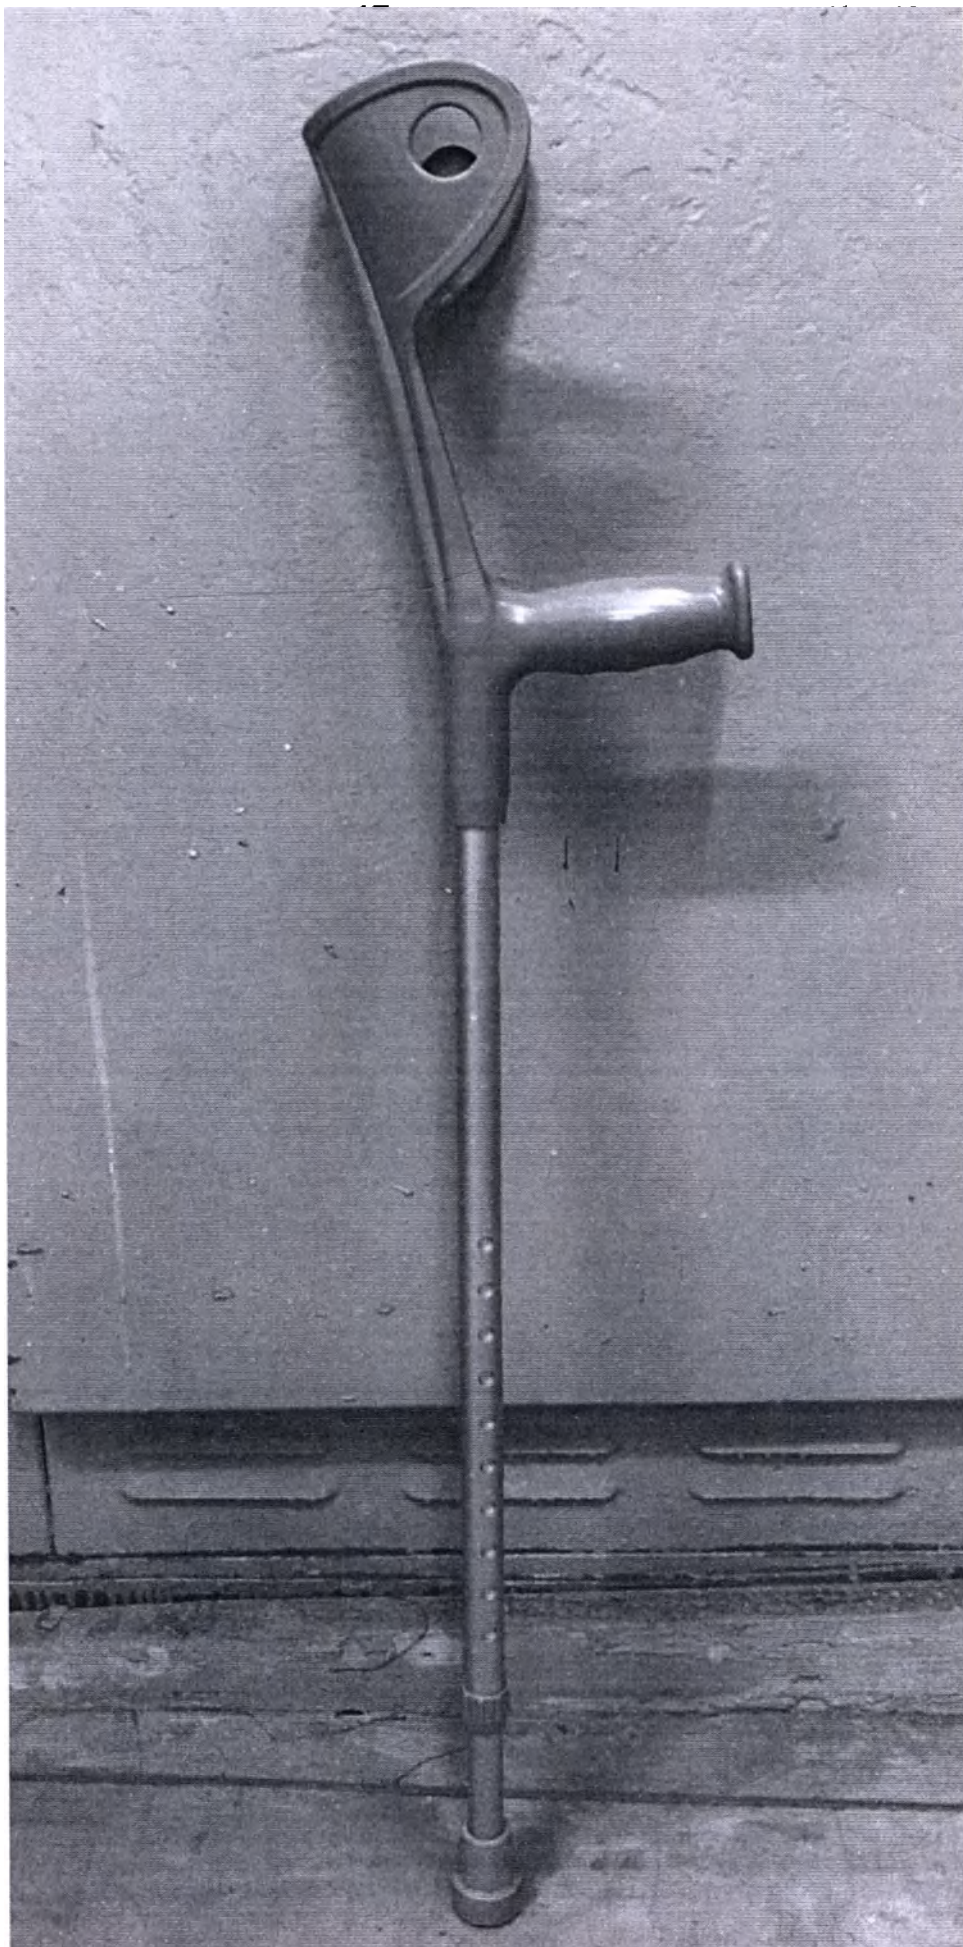


Рис. 3 – Средства для реабилитации: костыль подмышечный с УПС, модель Т.Р200У по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018



**Рис.4 – Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть,
модель Т.Р220 по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018**

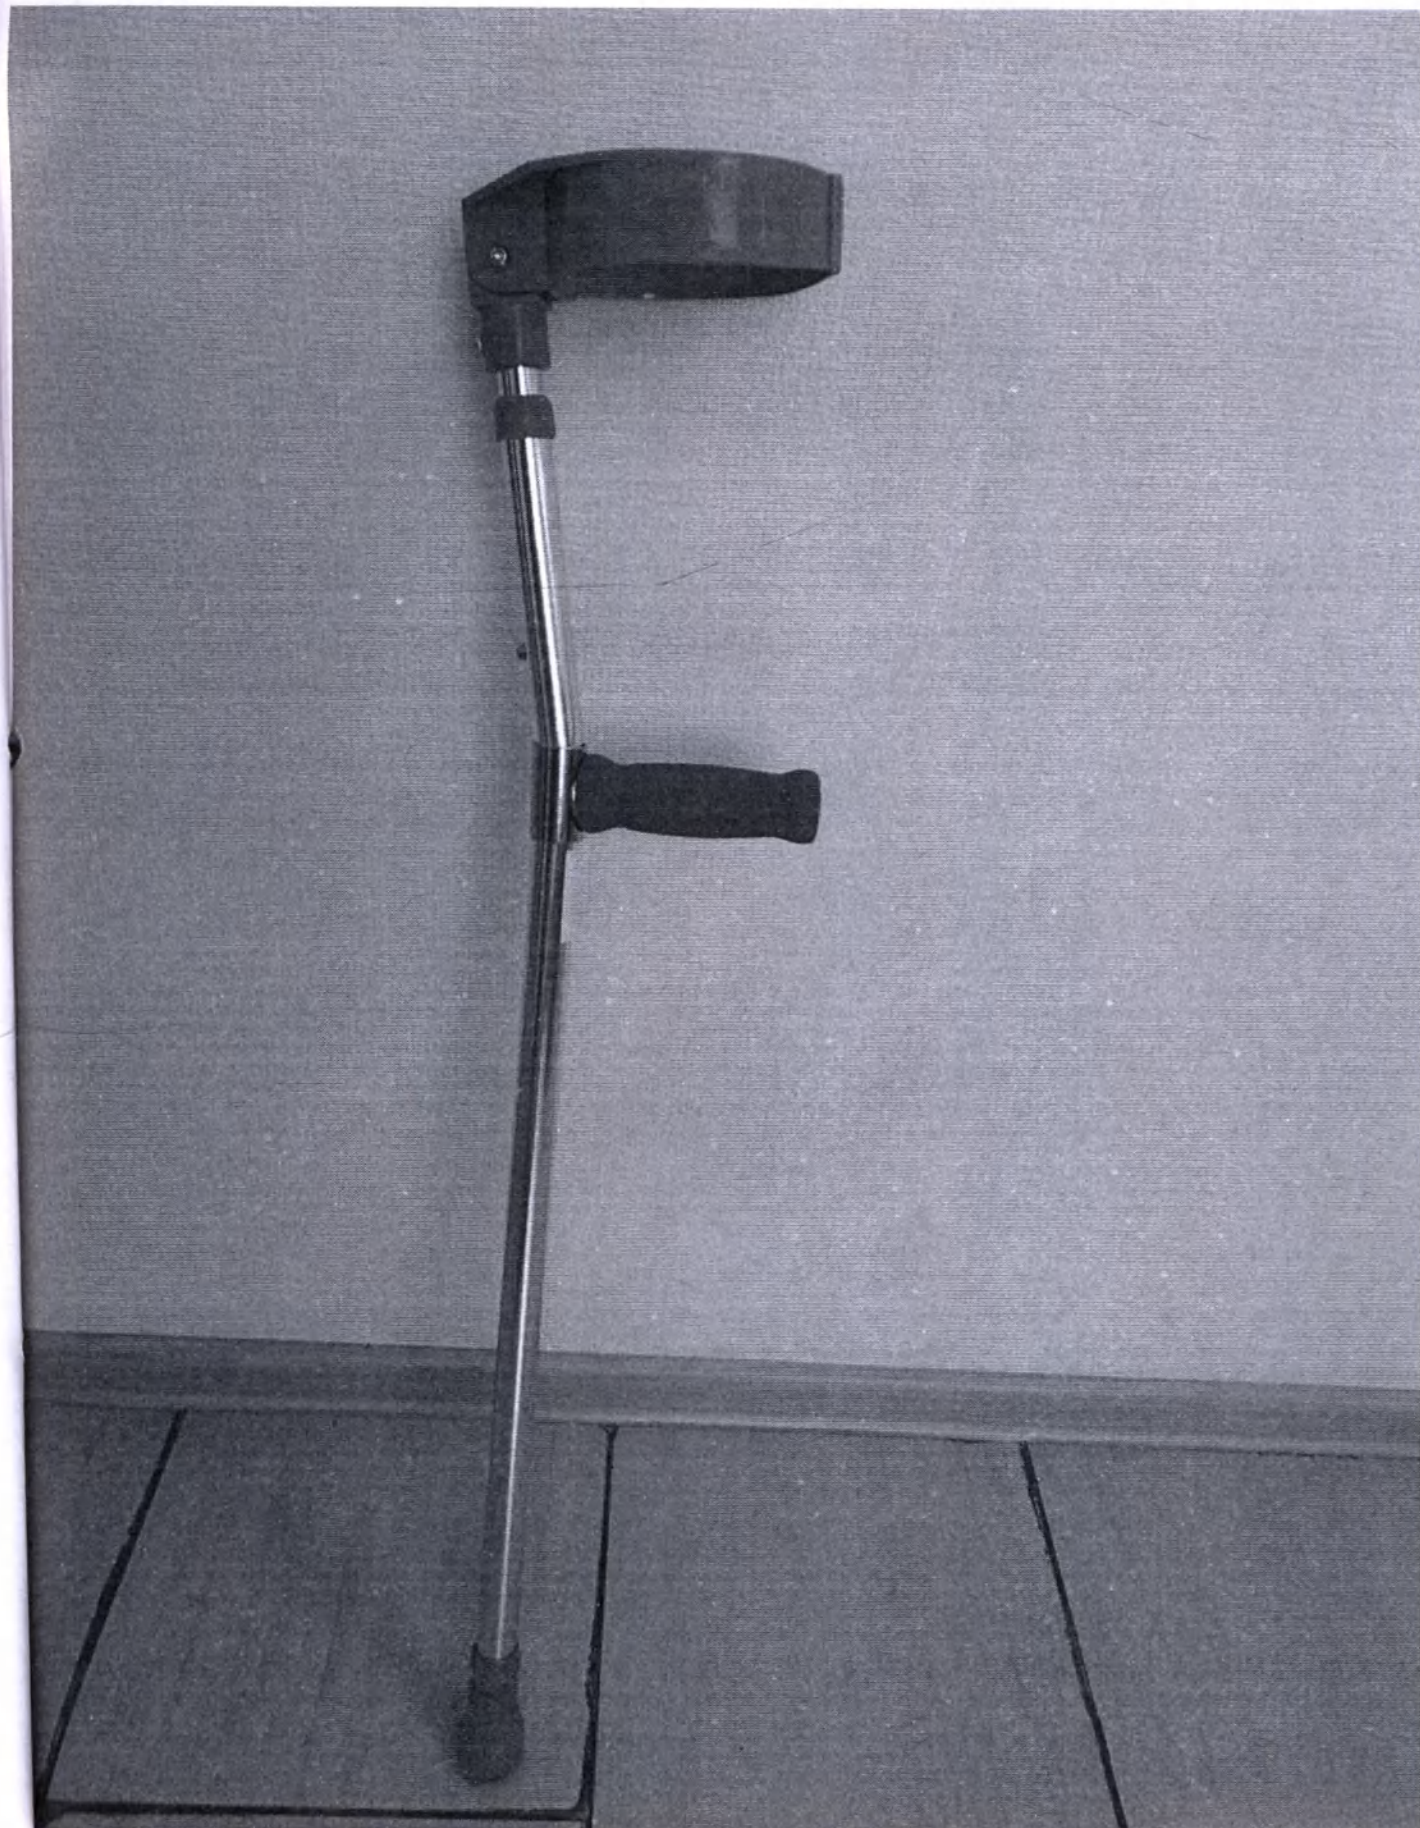


Рис.5 – Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть, модель Т.Р230
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018



Рис.6 – Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть, модель Т.Р231
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018



Рис.7 – Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть, модель Т.Р232
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

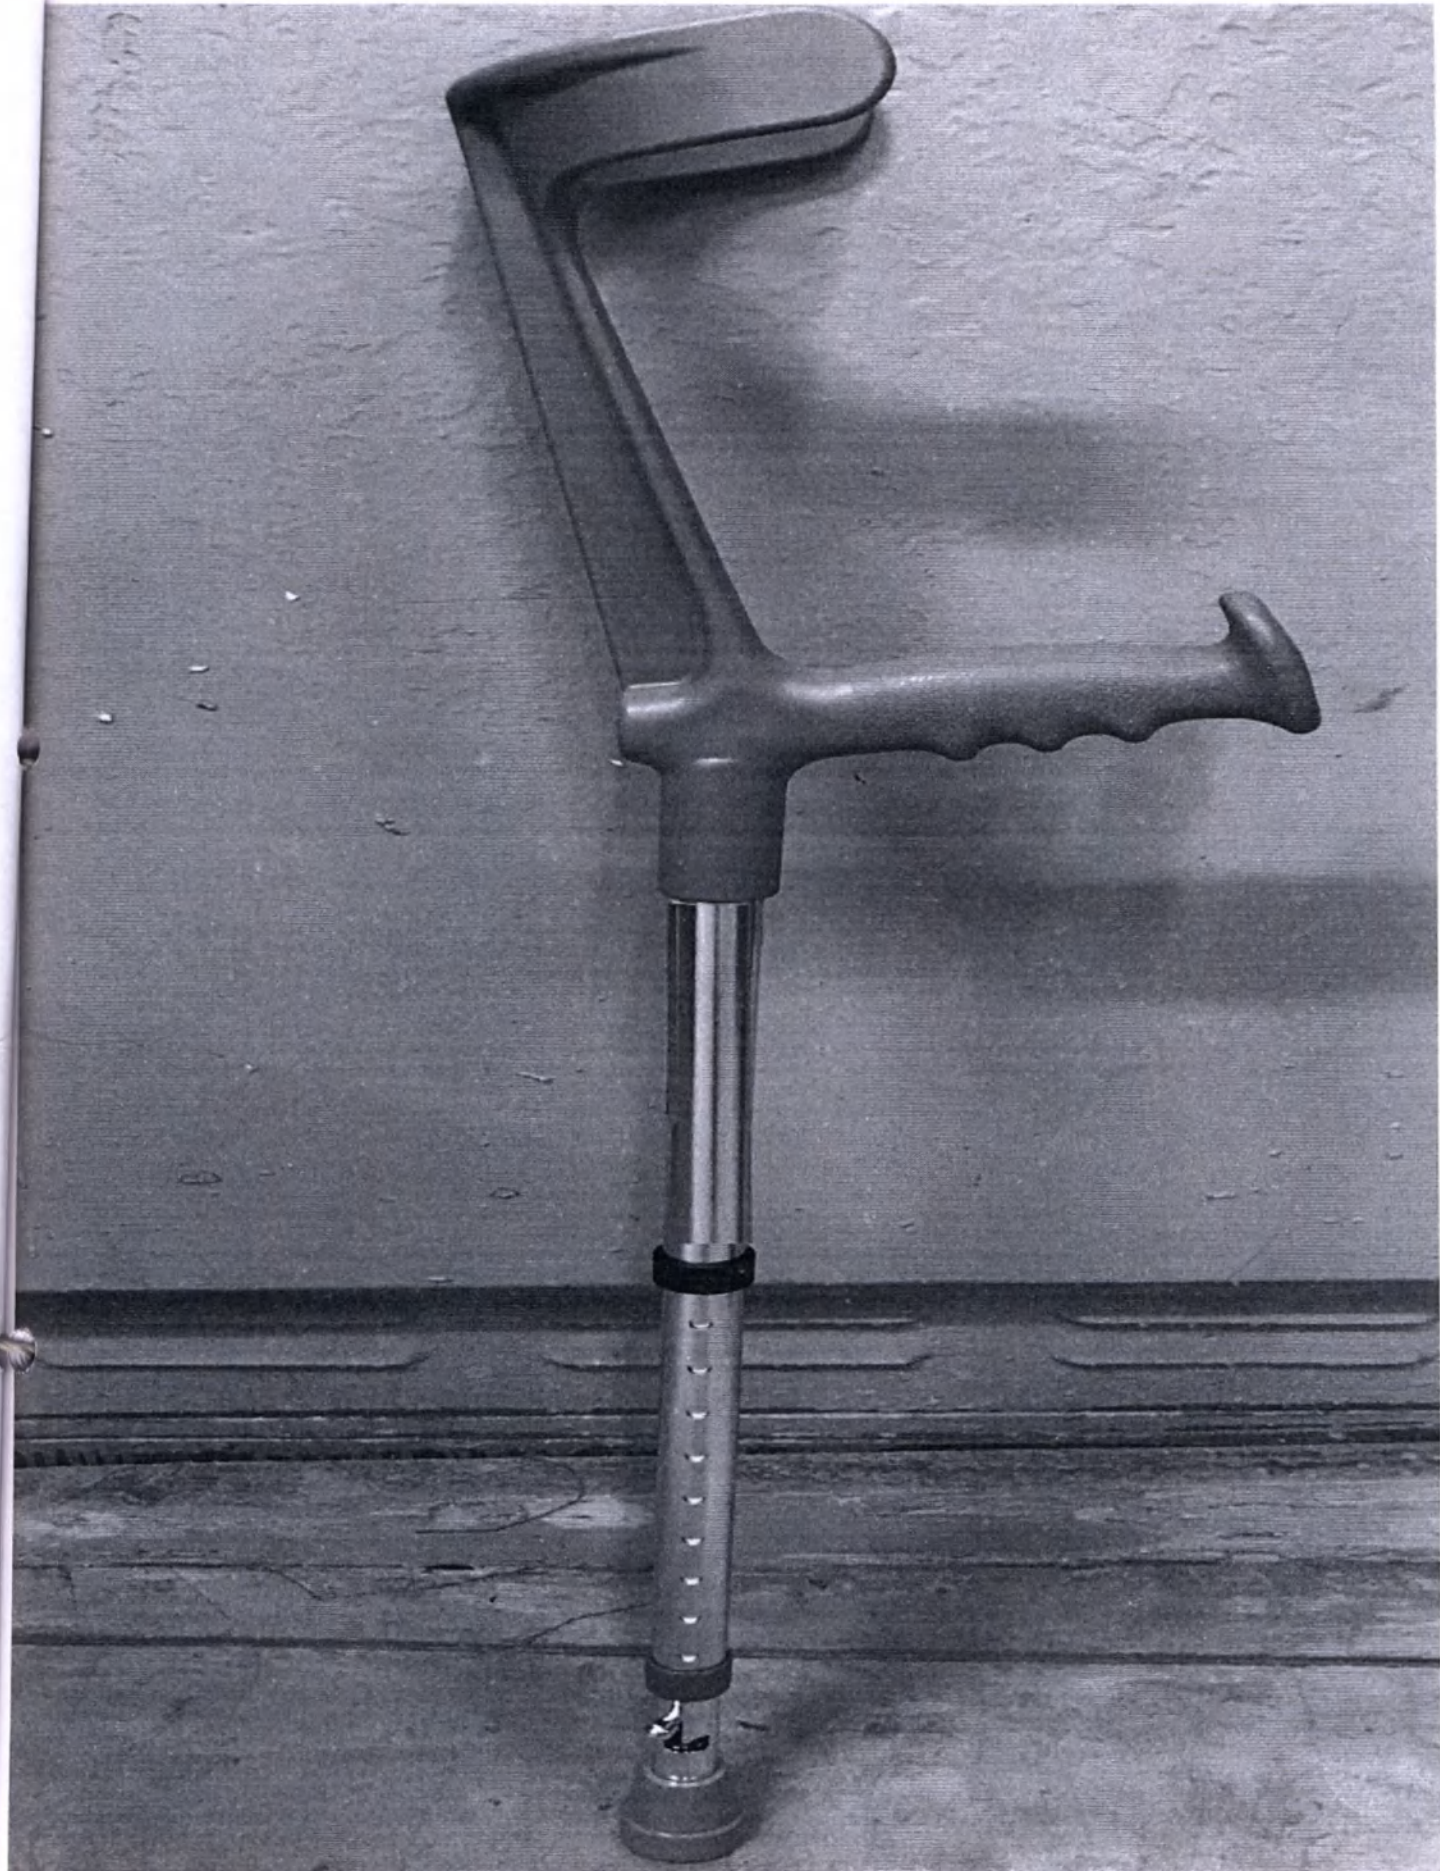


Рис.8 – Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть с УПС, модель Т.Р220У
по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

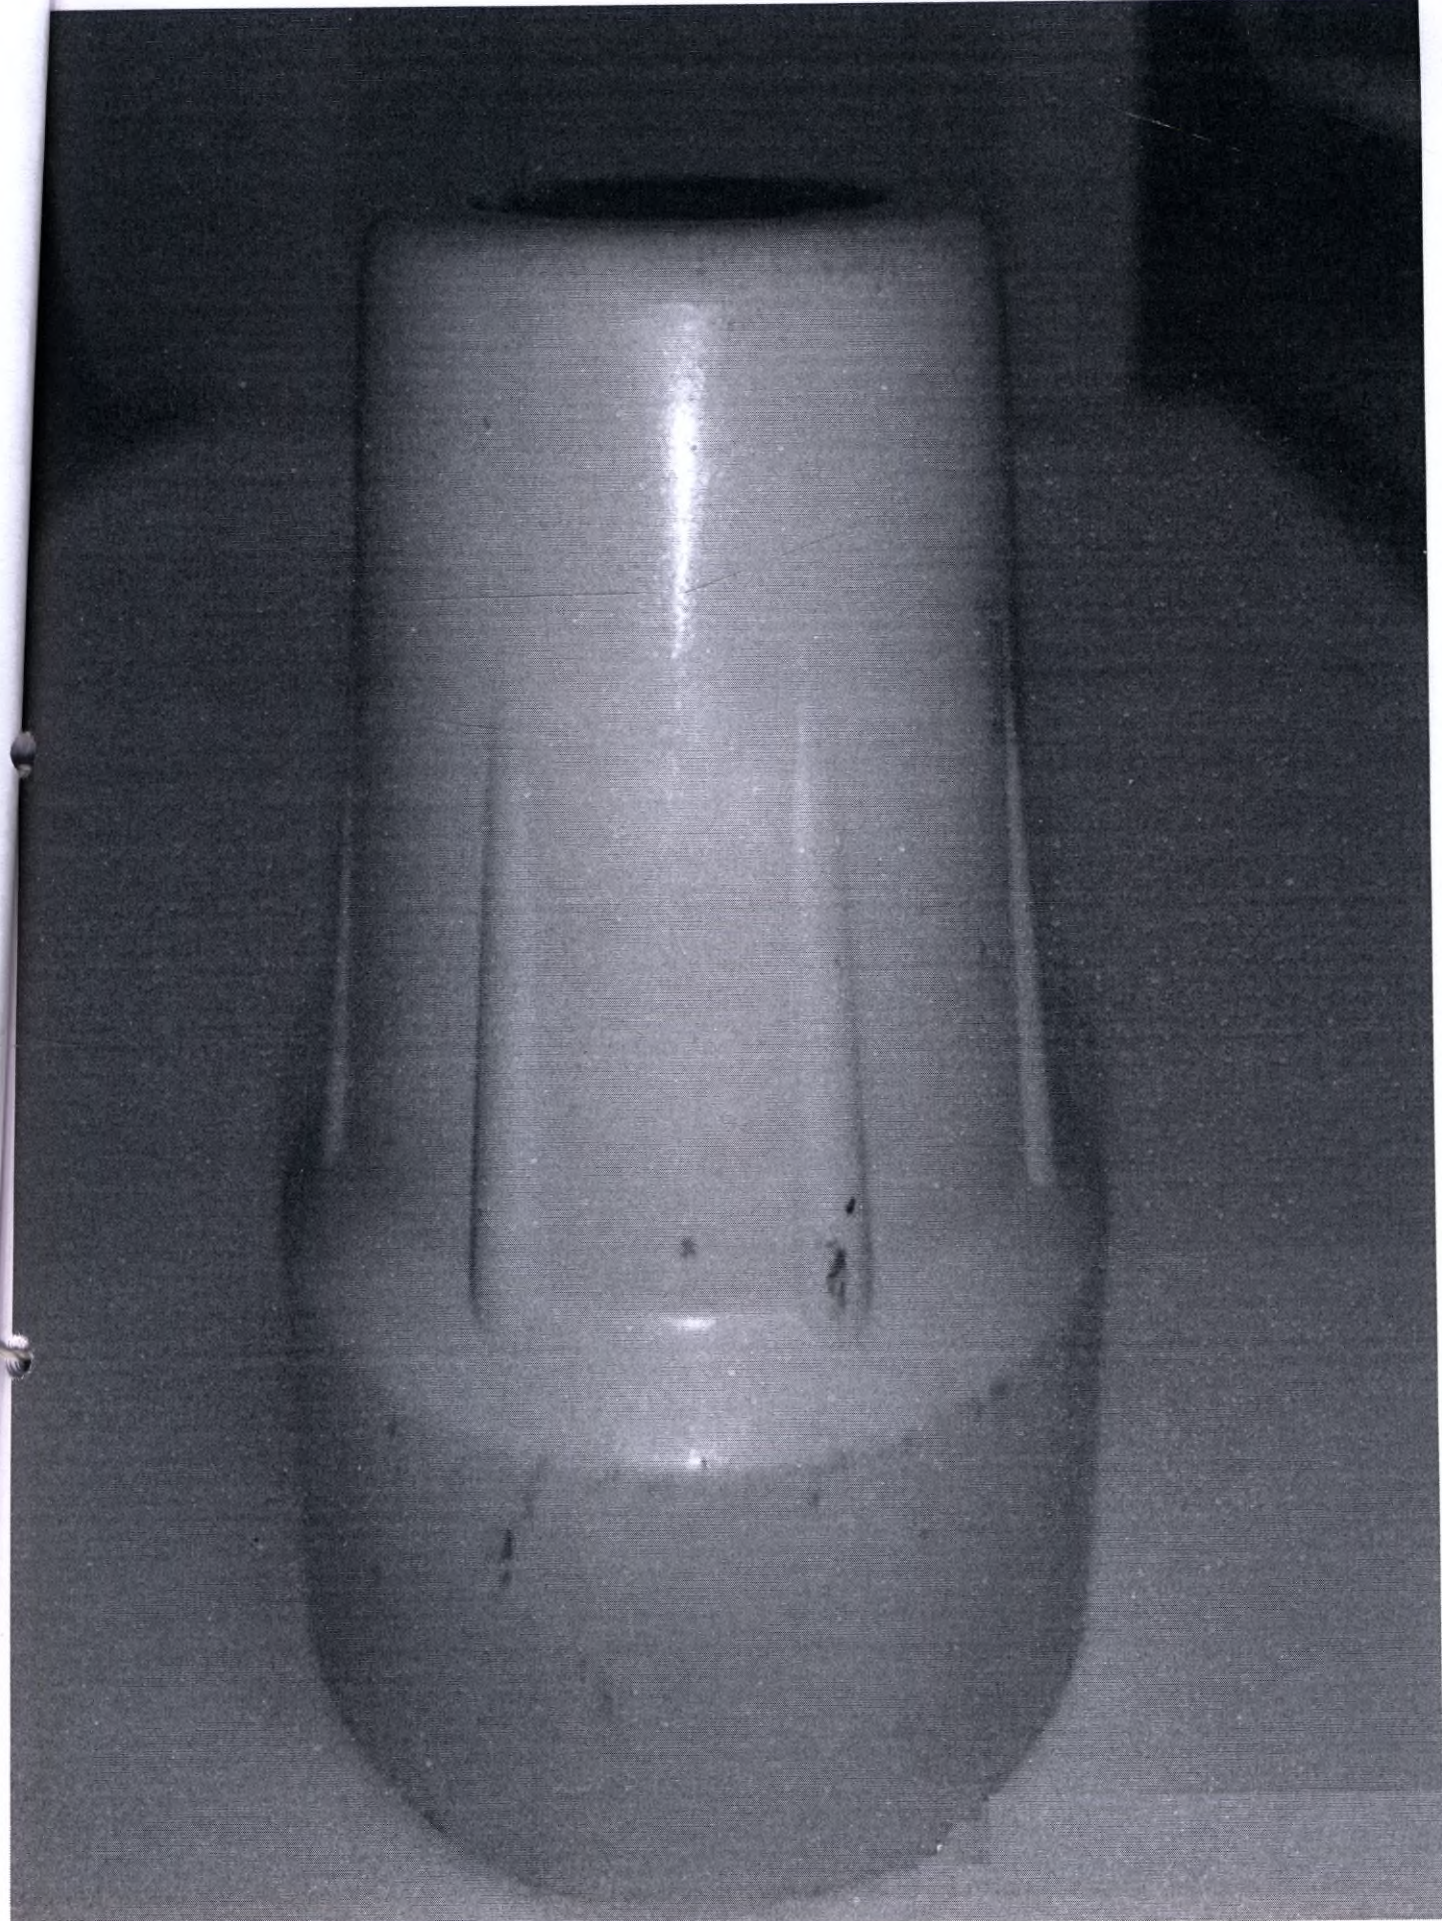


Рис.9 – Наконечник, модель Т.Р001

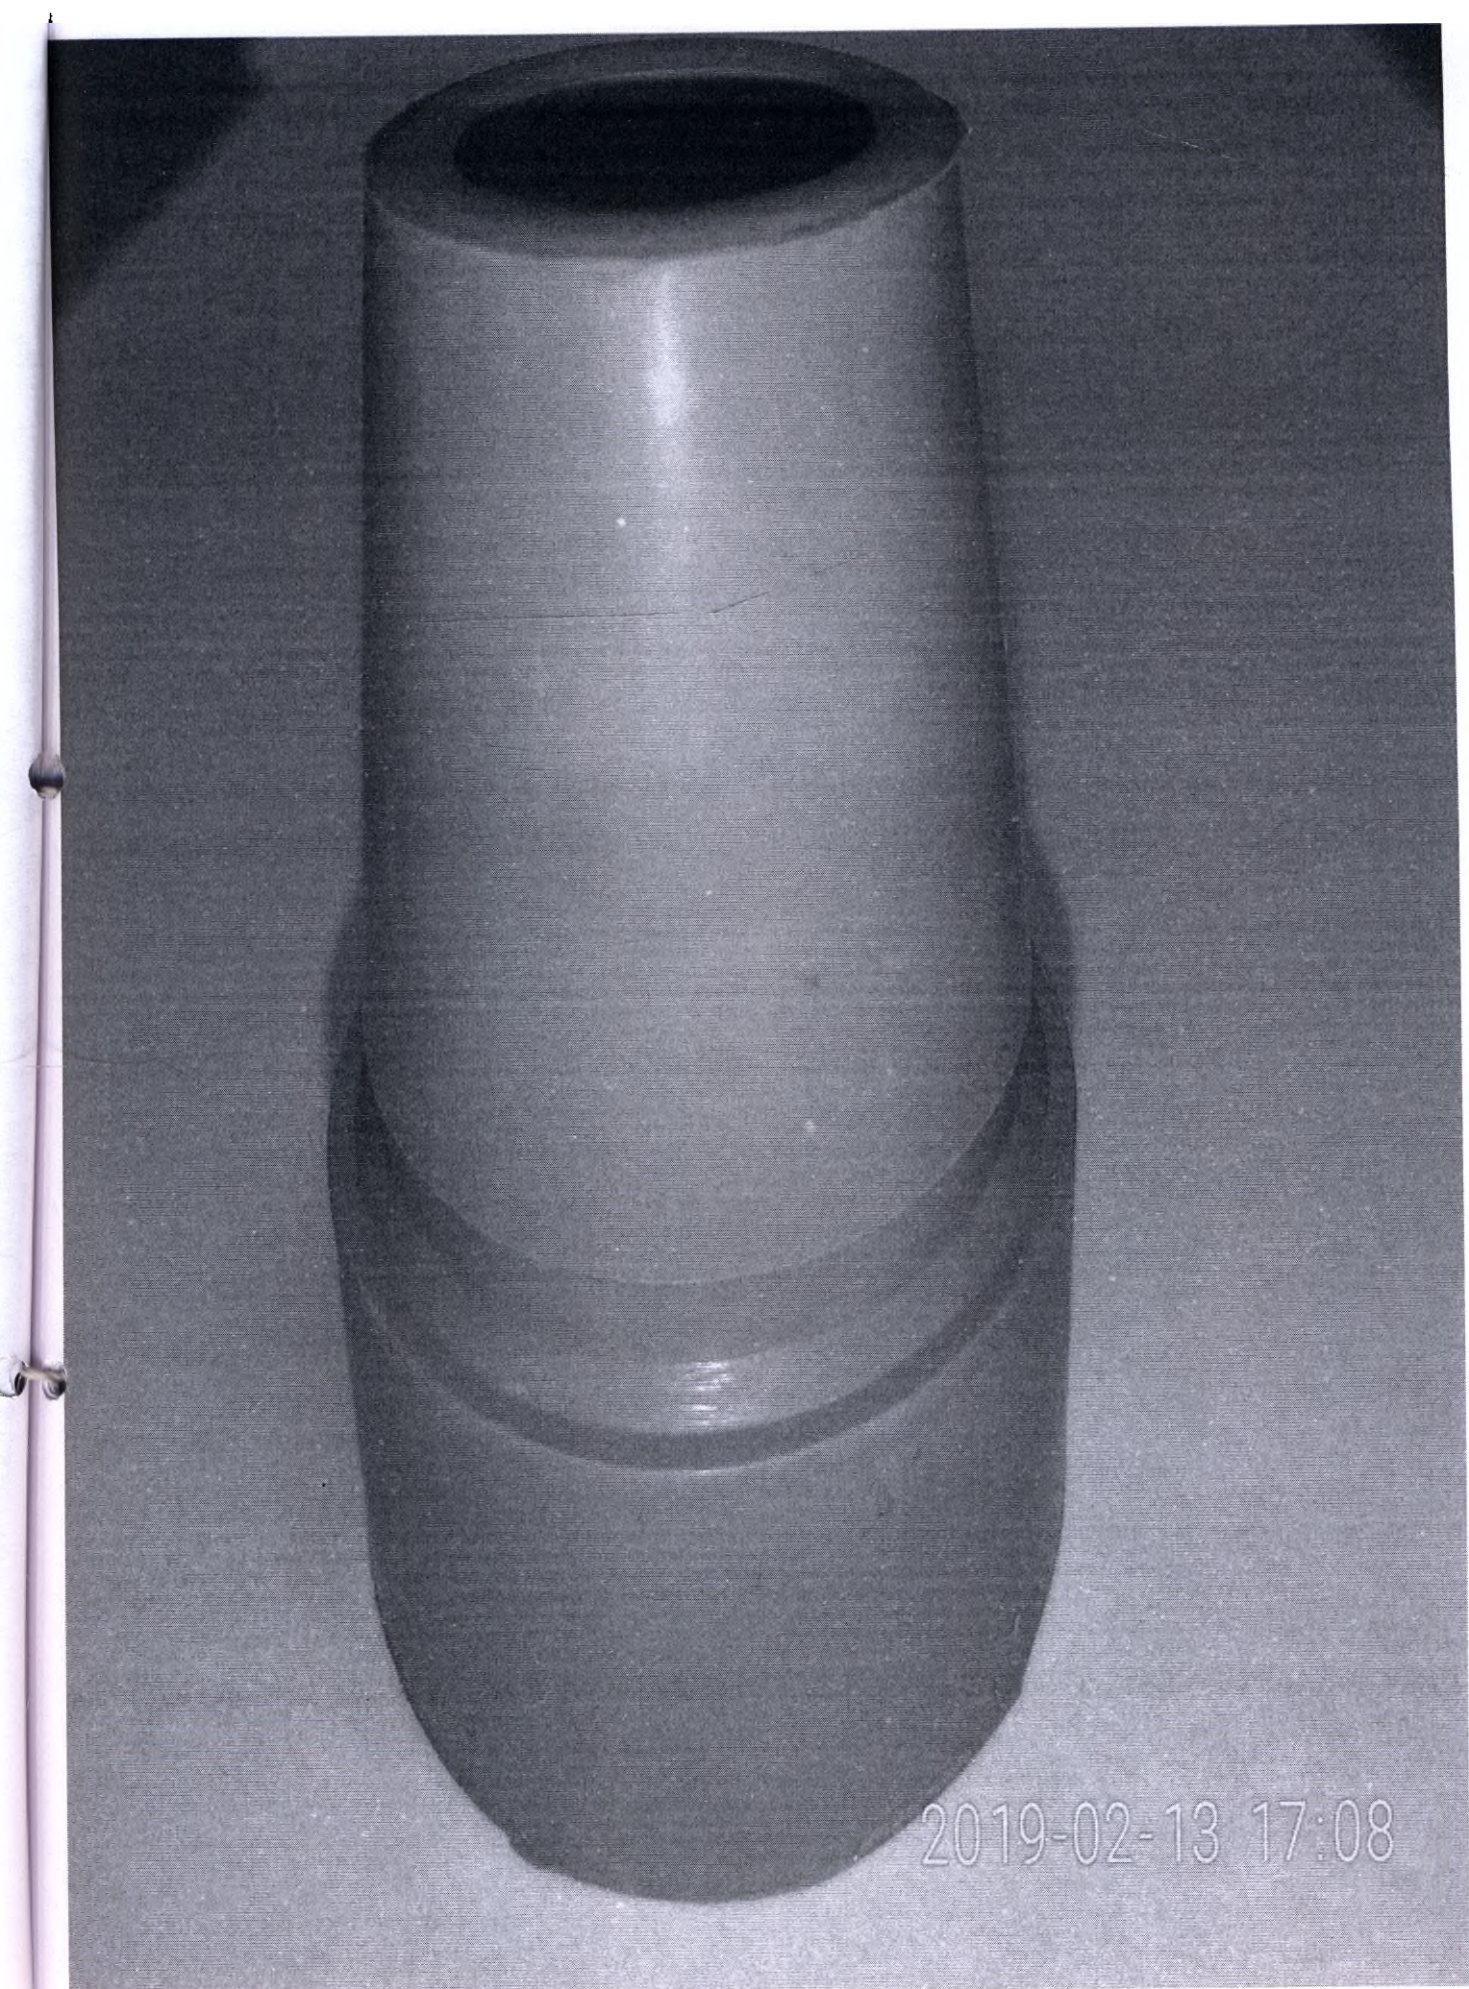


Рис.10 – Наконечник, модель Т.Р002

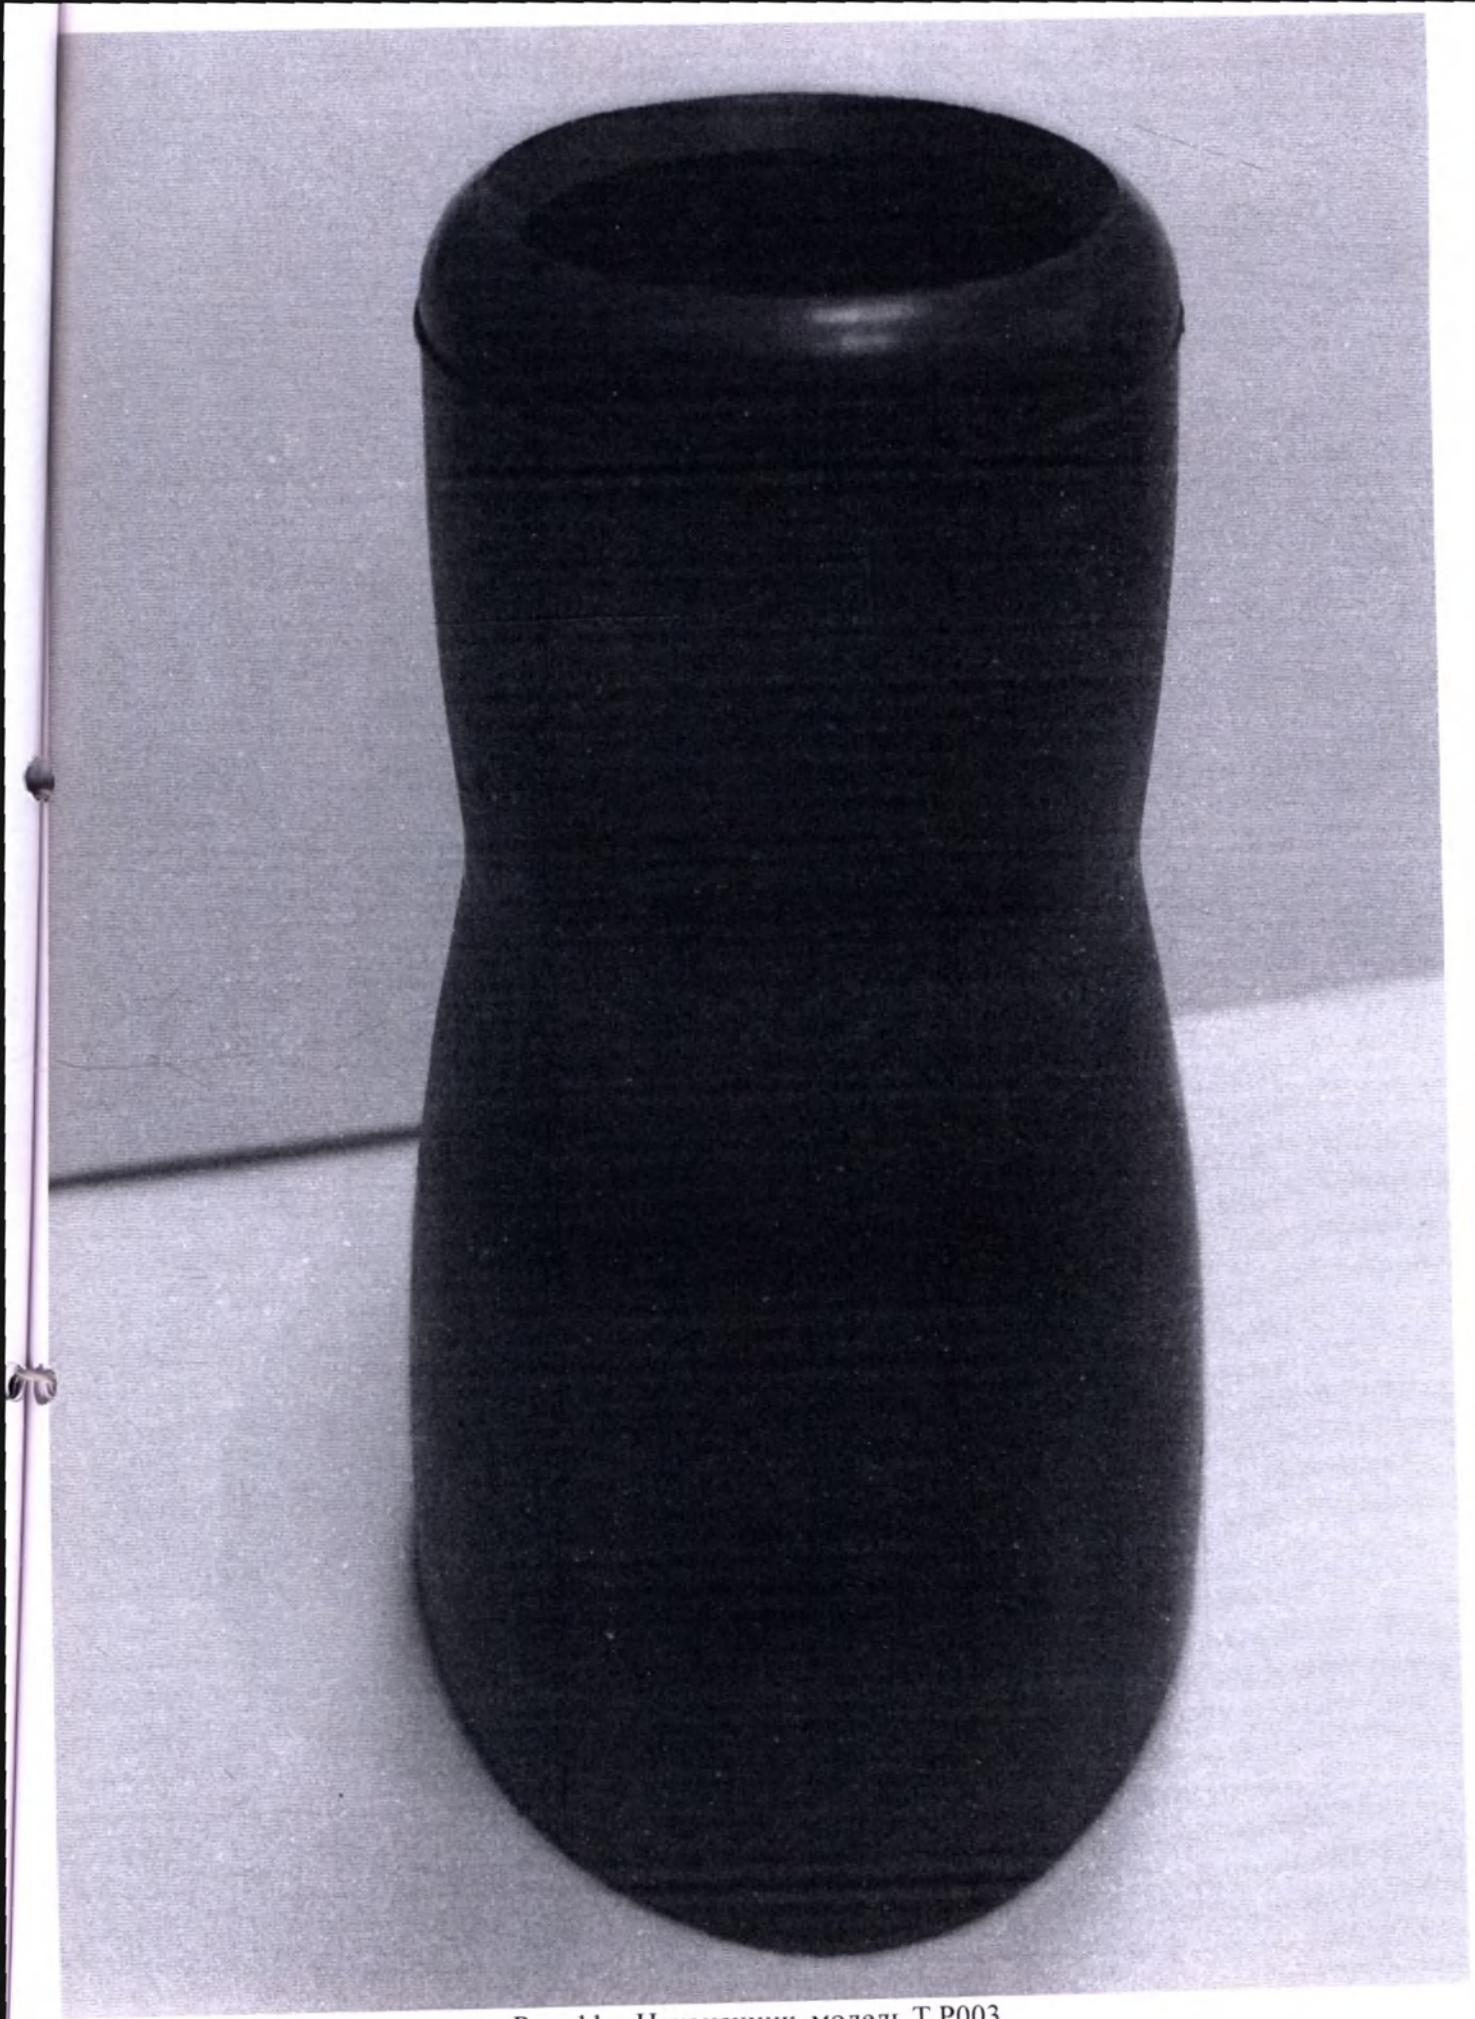


Рис. 11 – Наконечник, модель Т.Р003



Рис.12 – Наконечник, модель Т.Р004

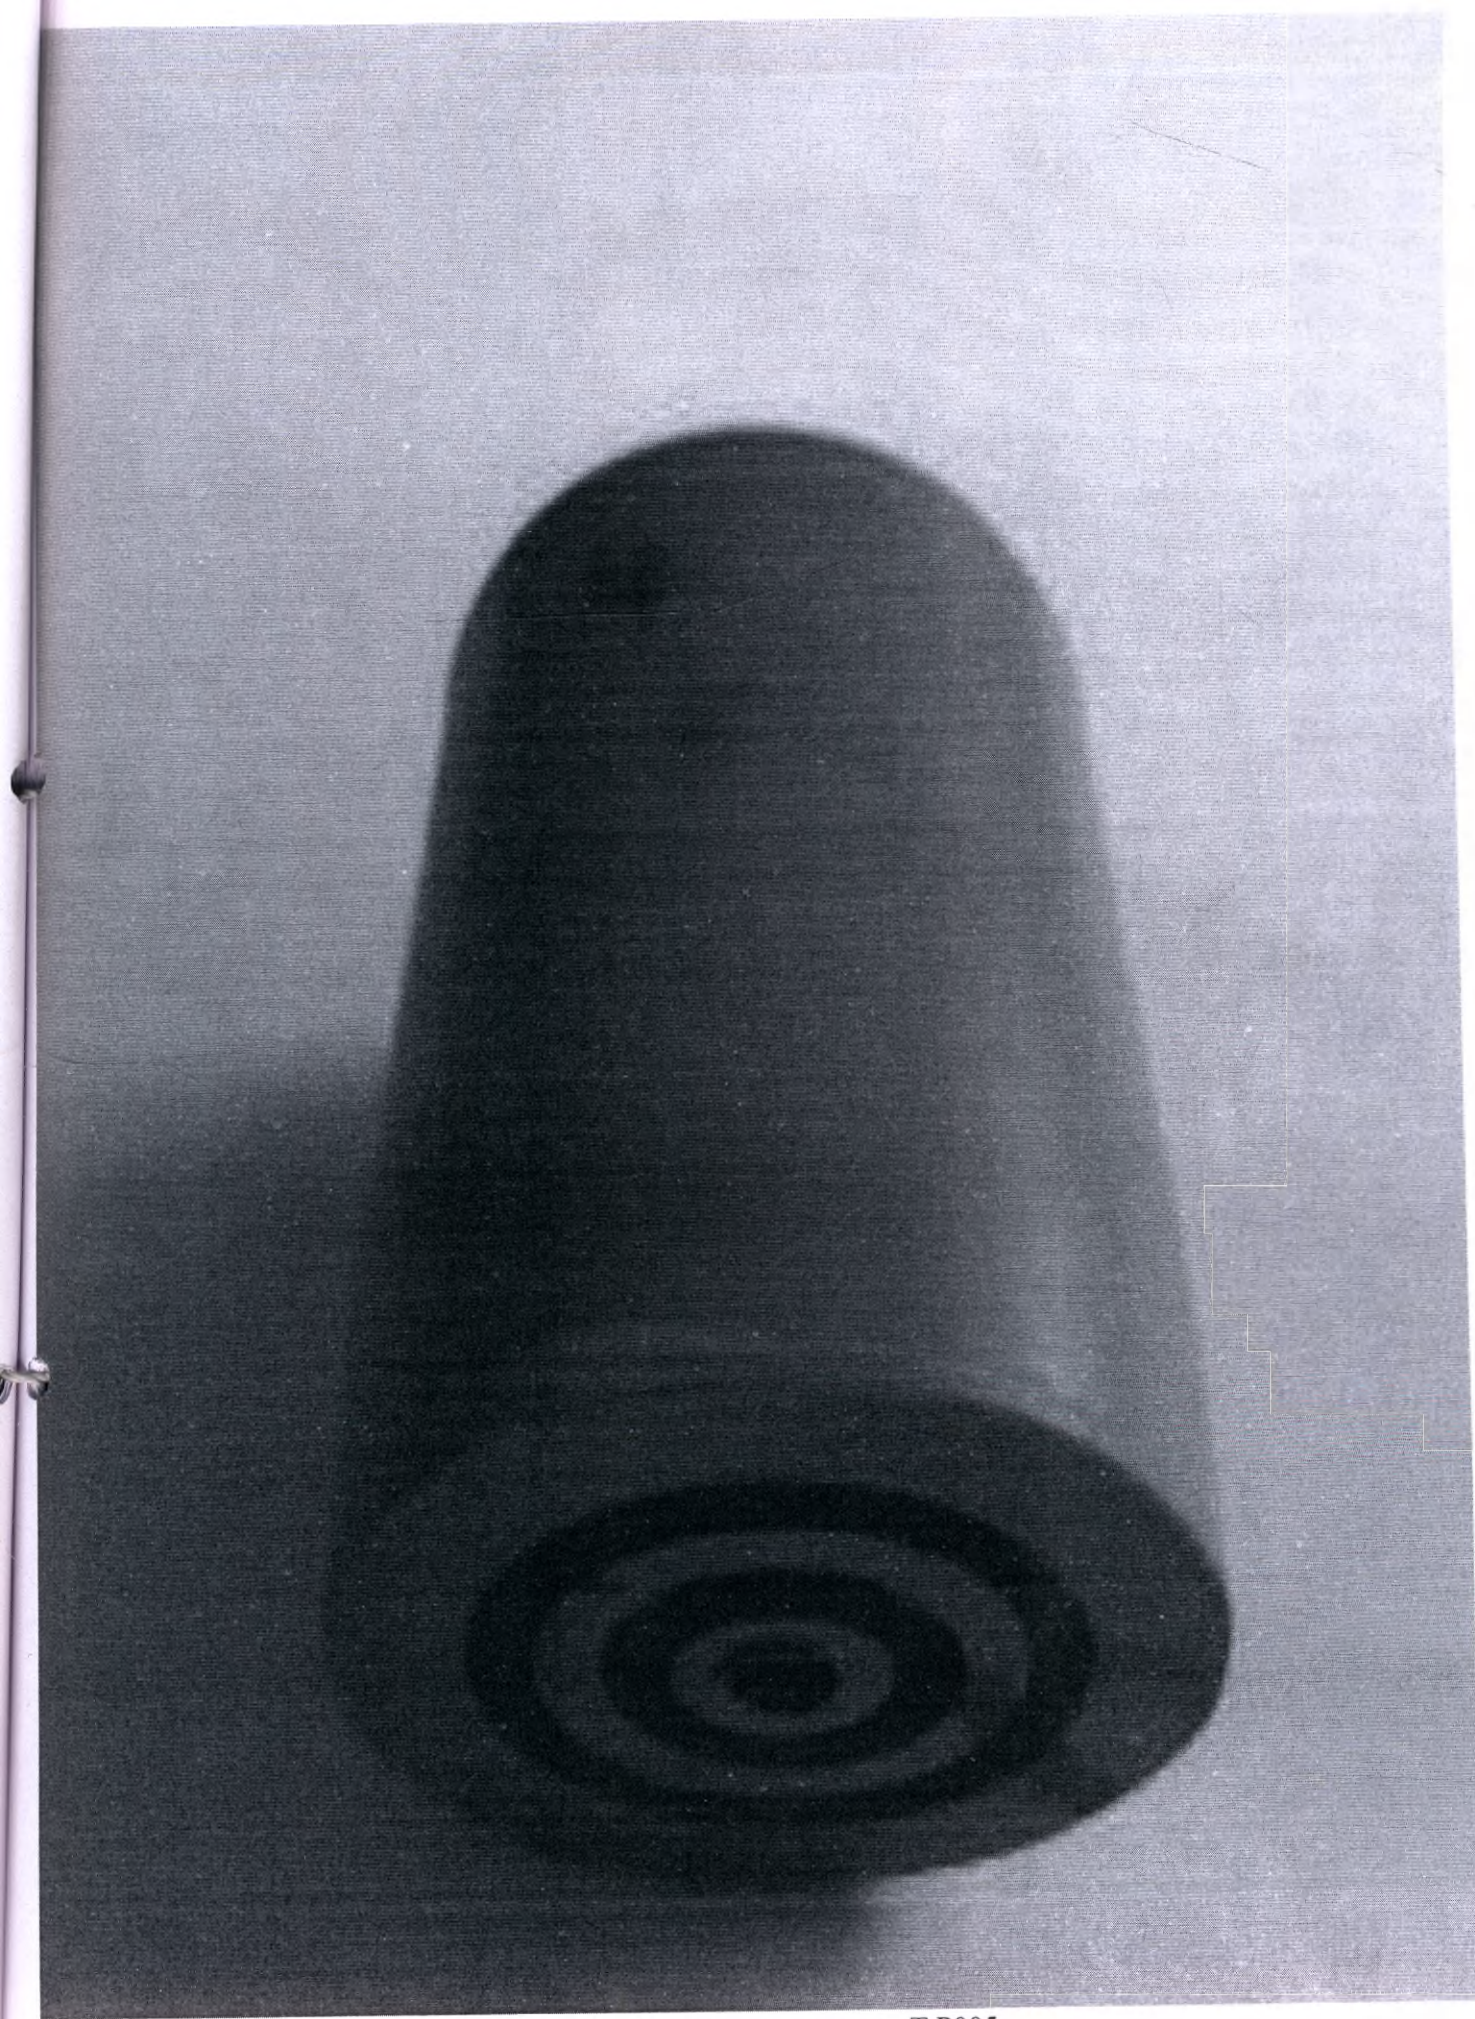


Рис.13 – Наконечник, модель Т.Р005

2019-02-21 13:35



Рис.14 – Наконечник, модель Т.Р006



Рис.15 – Наконечник, модель Т.Р007

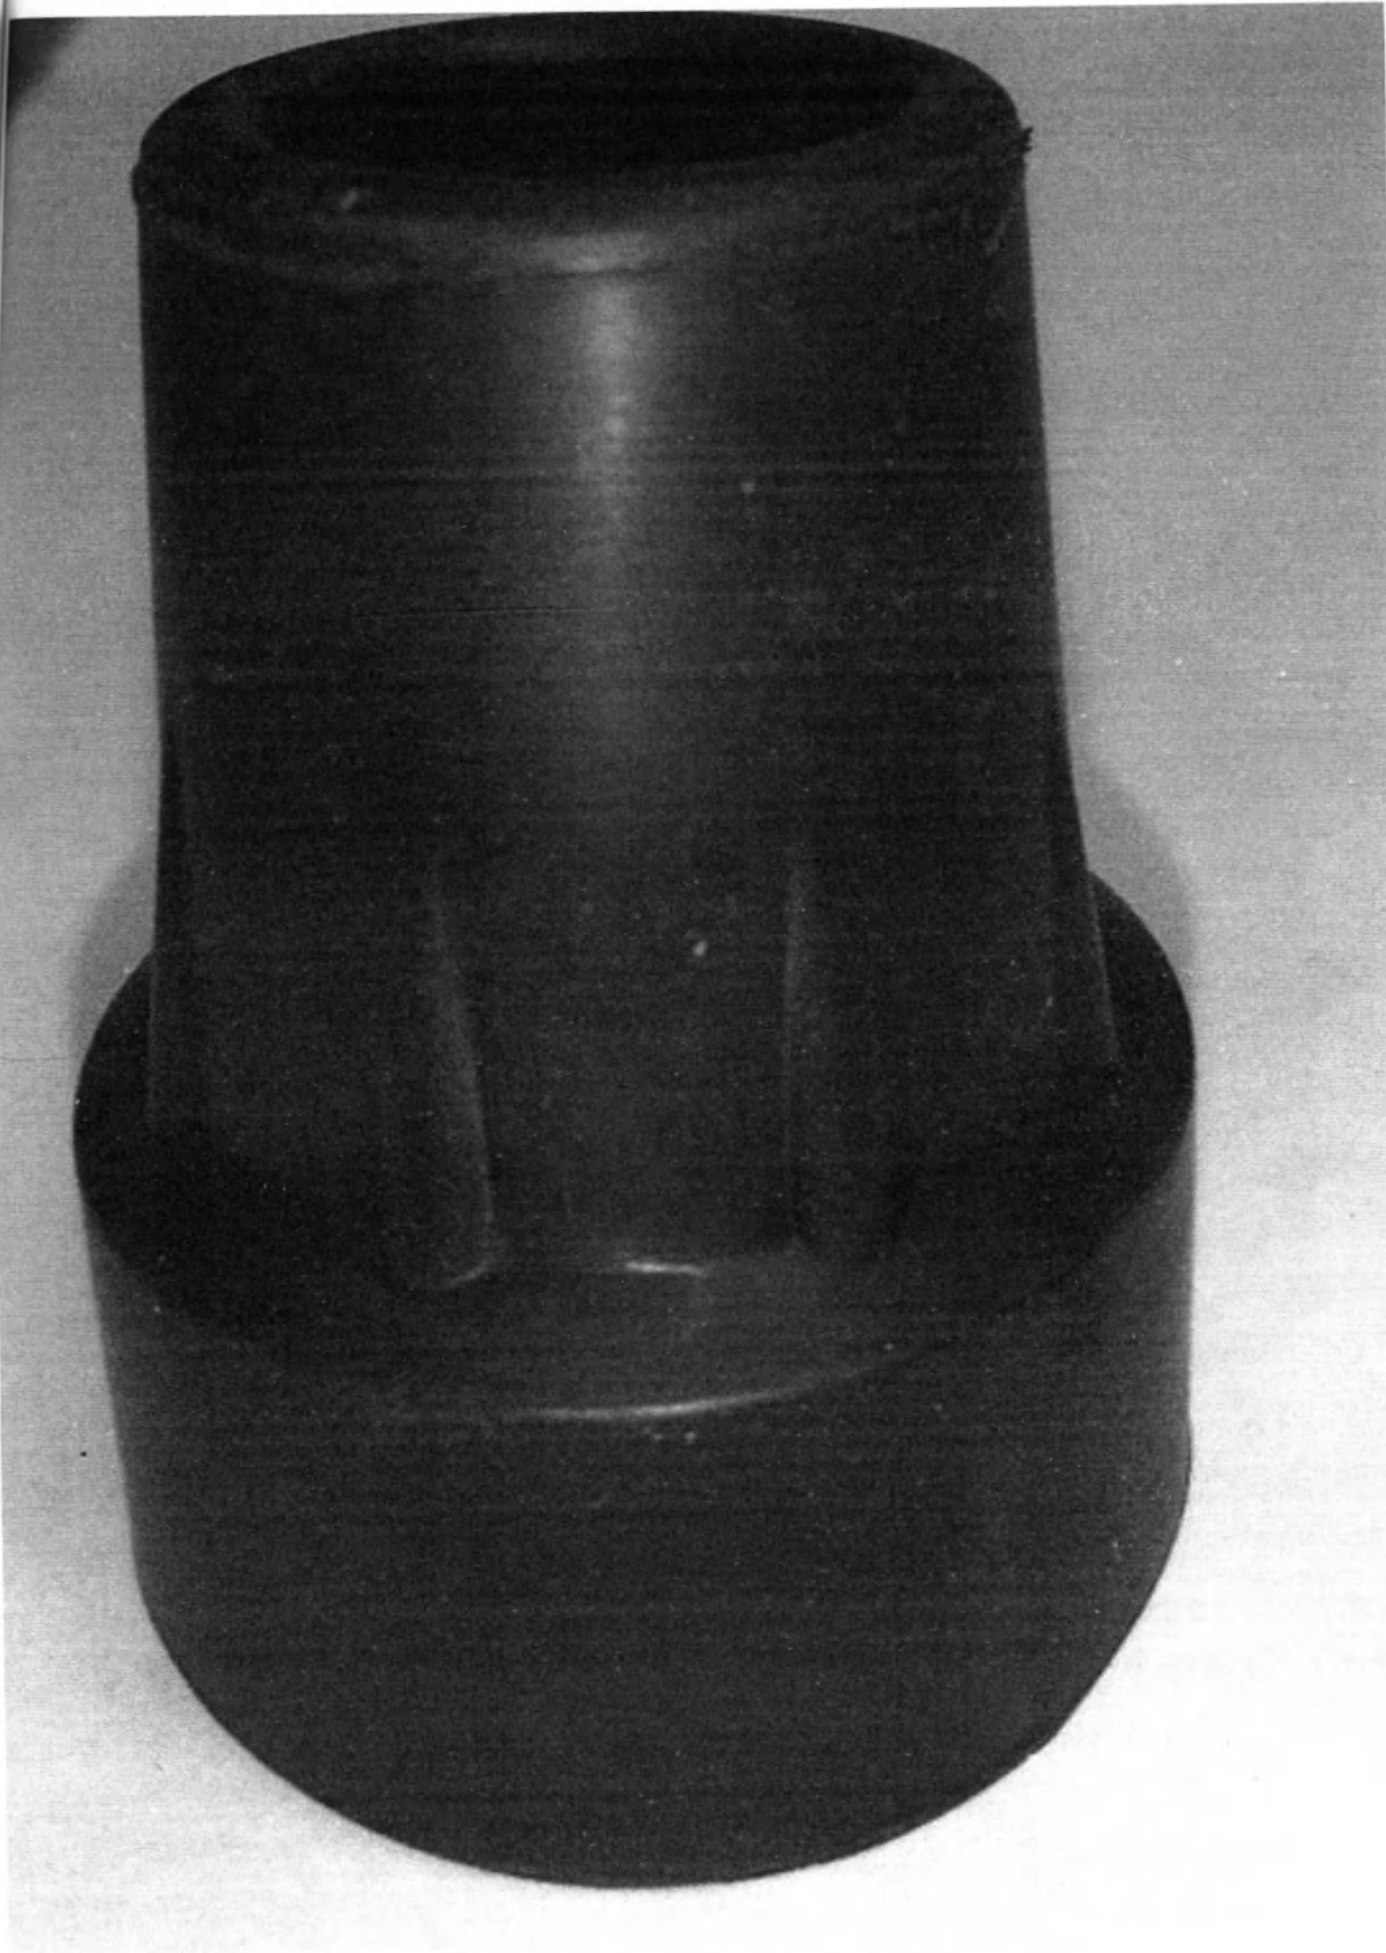


Рис.16 – Наконечник, модель Т.Р008

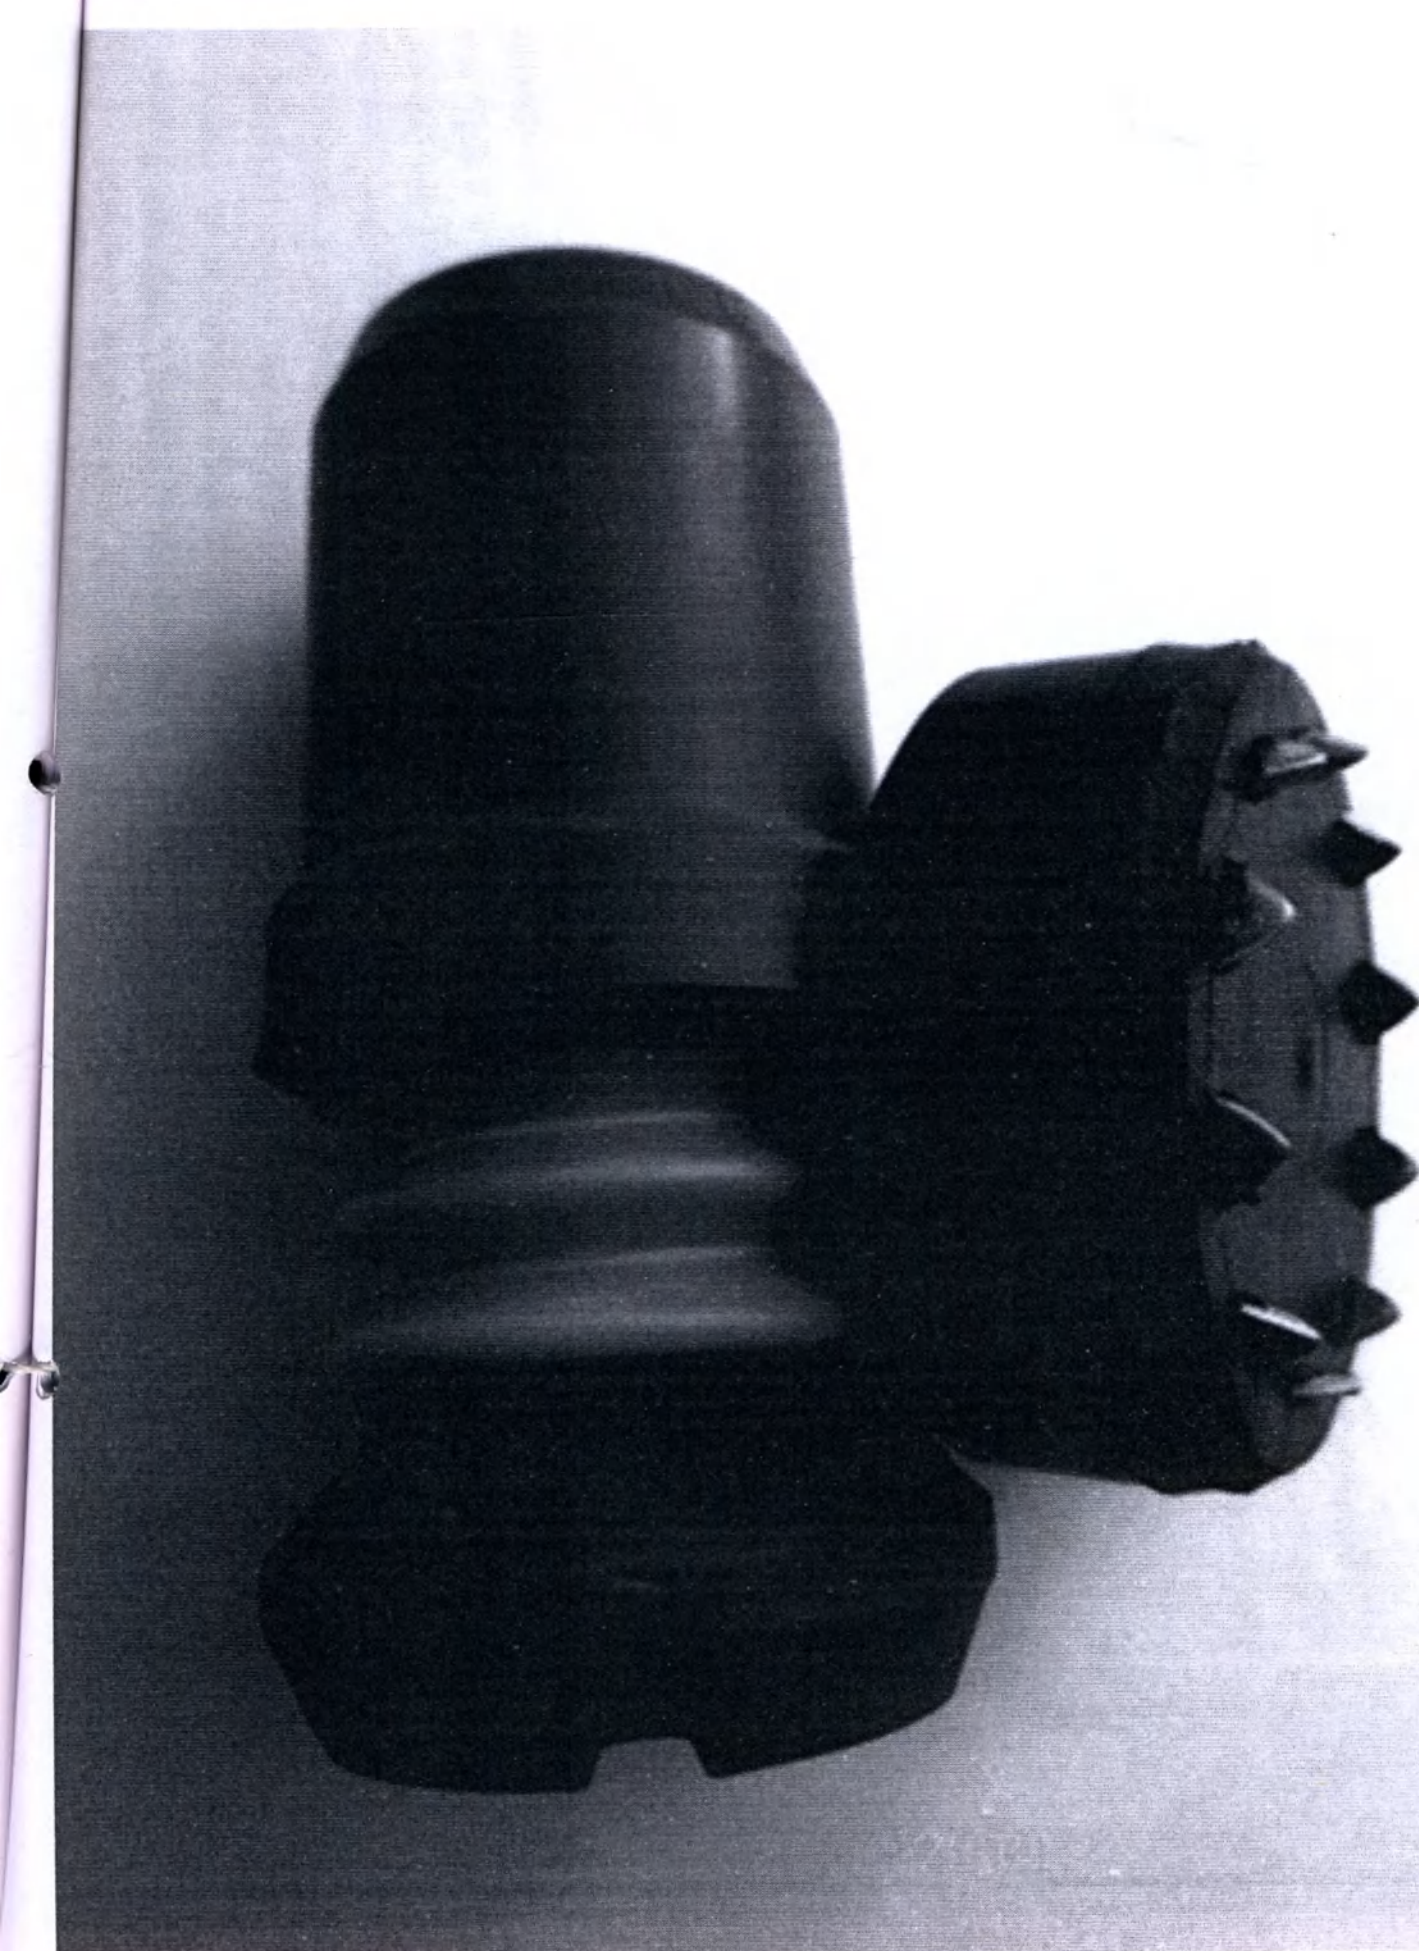


Рис.17 – Наконечник, модель Т.Р009

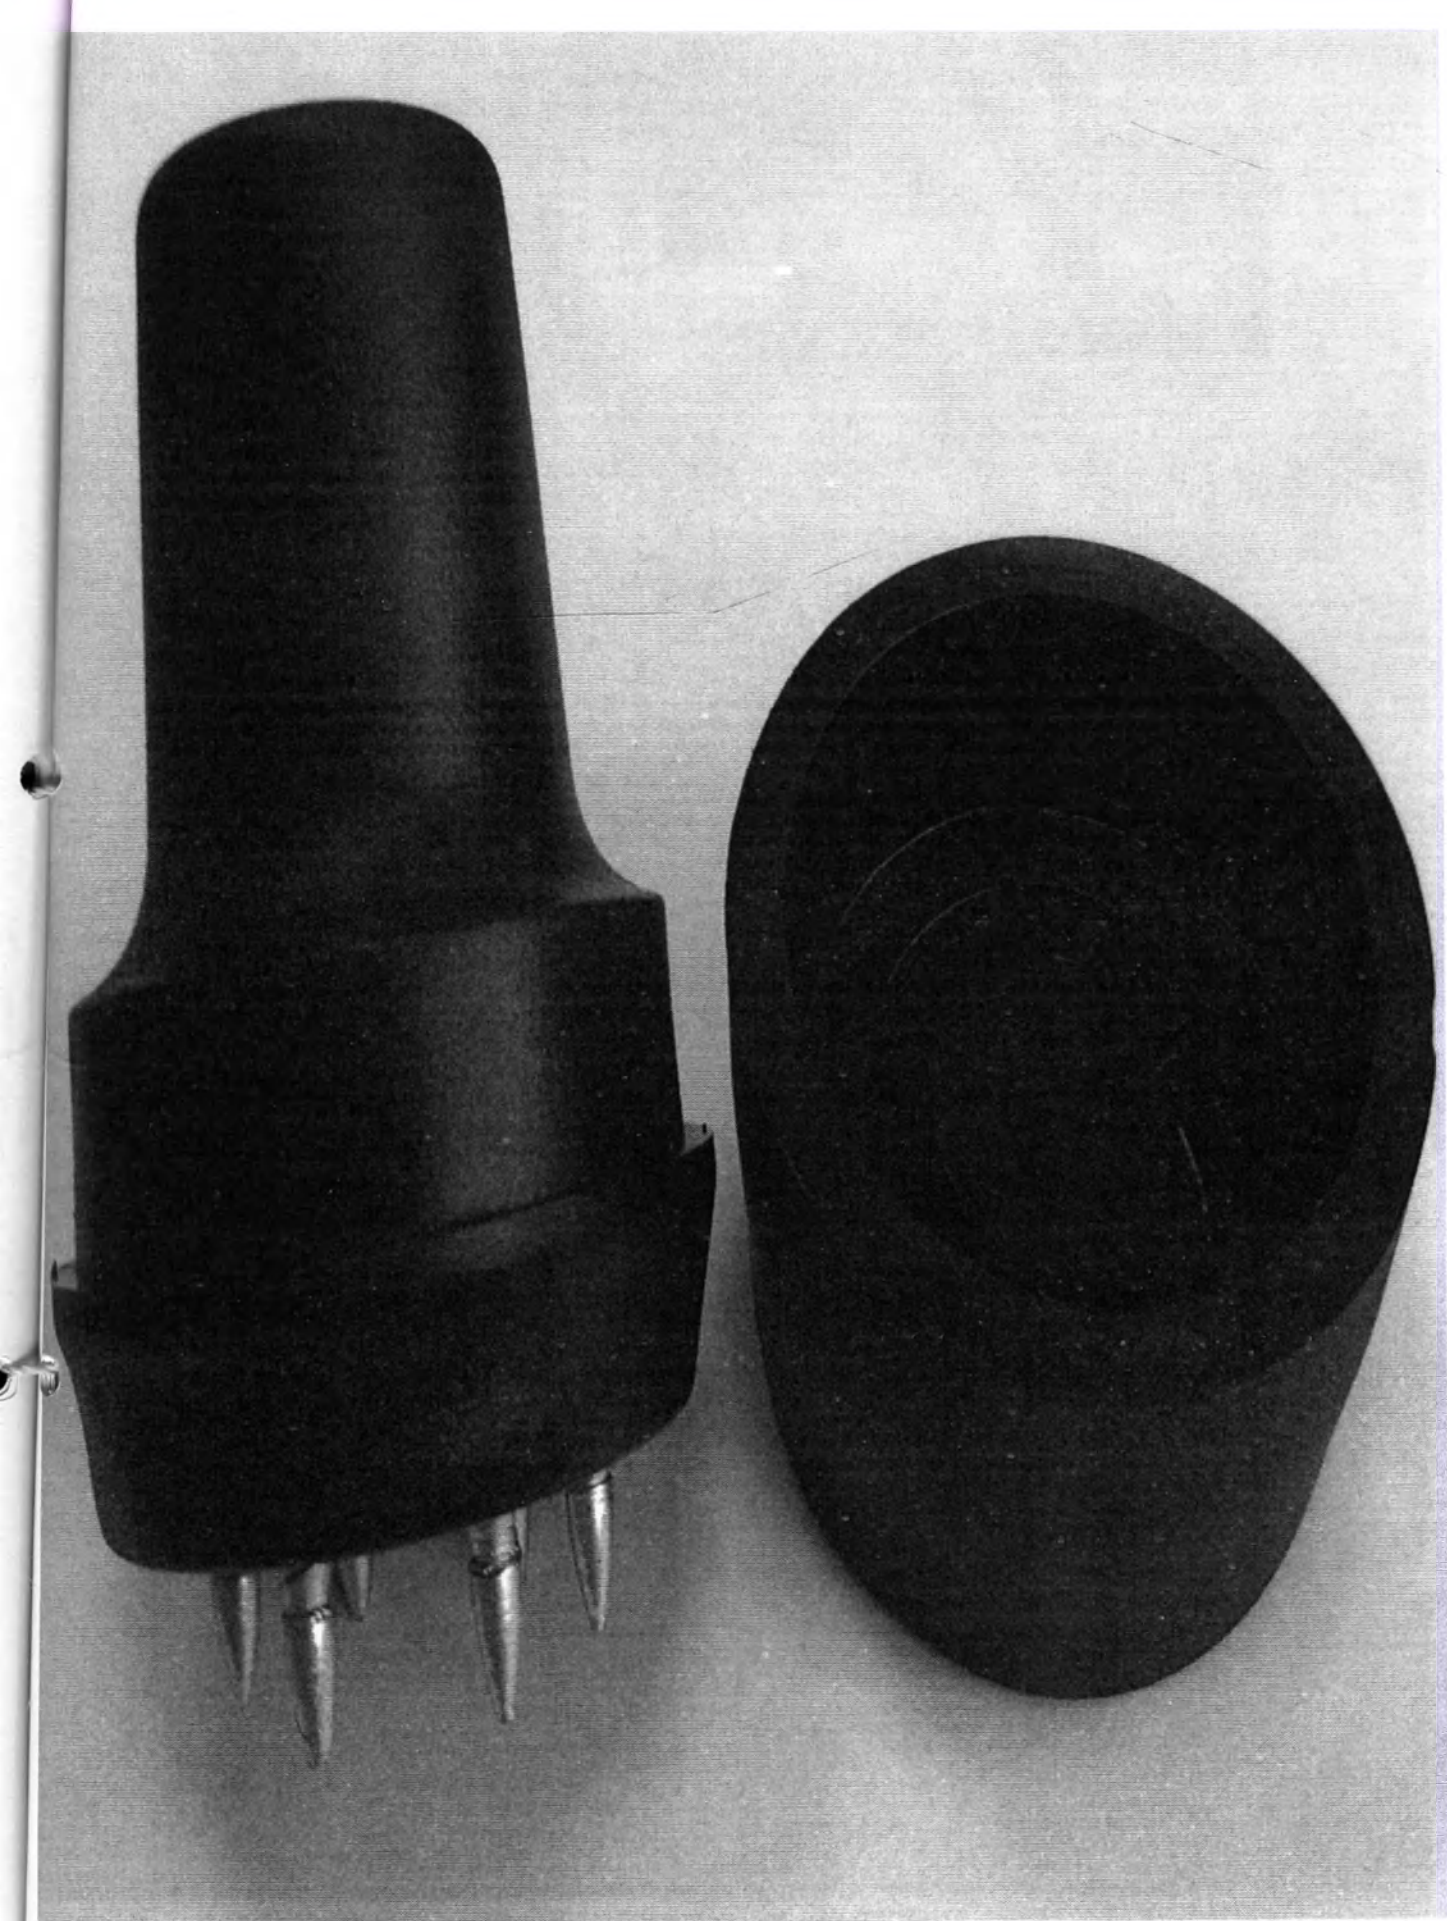


Рис.18 – Наконечник, модель Т.Р010



Рис.19 – Наконечник, модель Т.Р011



Рис.20 – Наконечник, модель Т.Р012



Рис.21 – Наконечник, модель Т.Р013

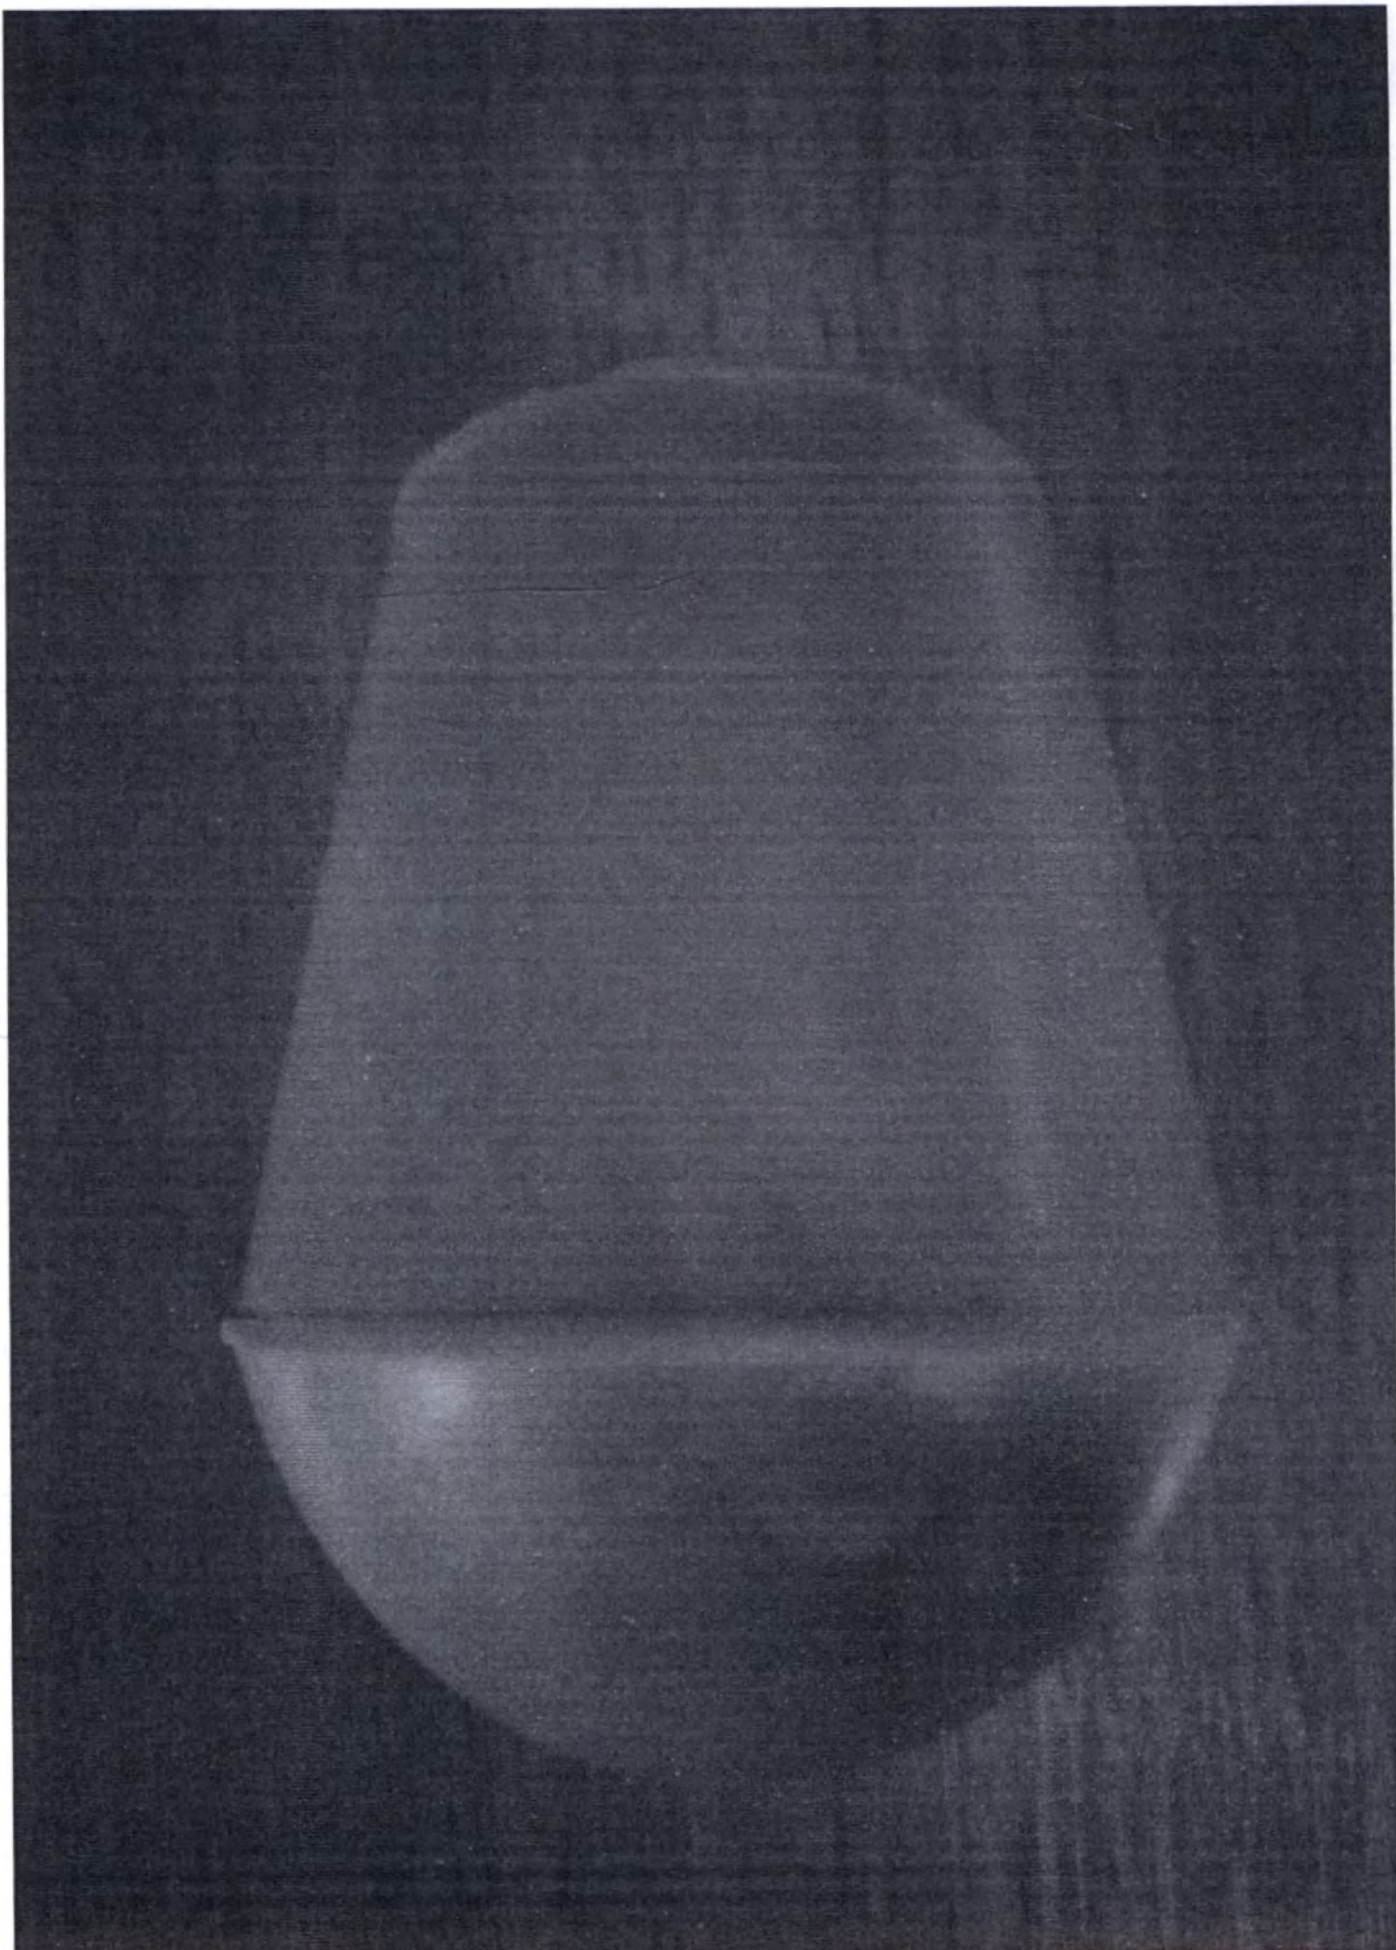


Рис.22 – Наконечник, модель Т.Р014



Рис.23 – Наконечник, модель Т.Р015

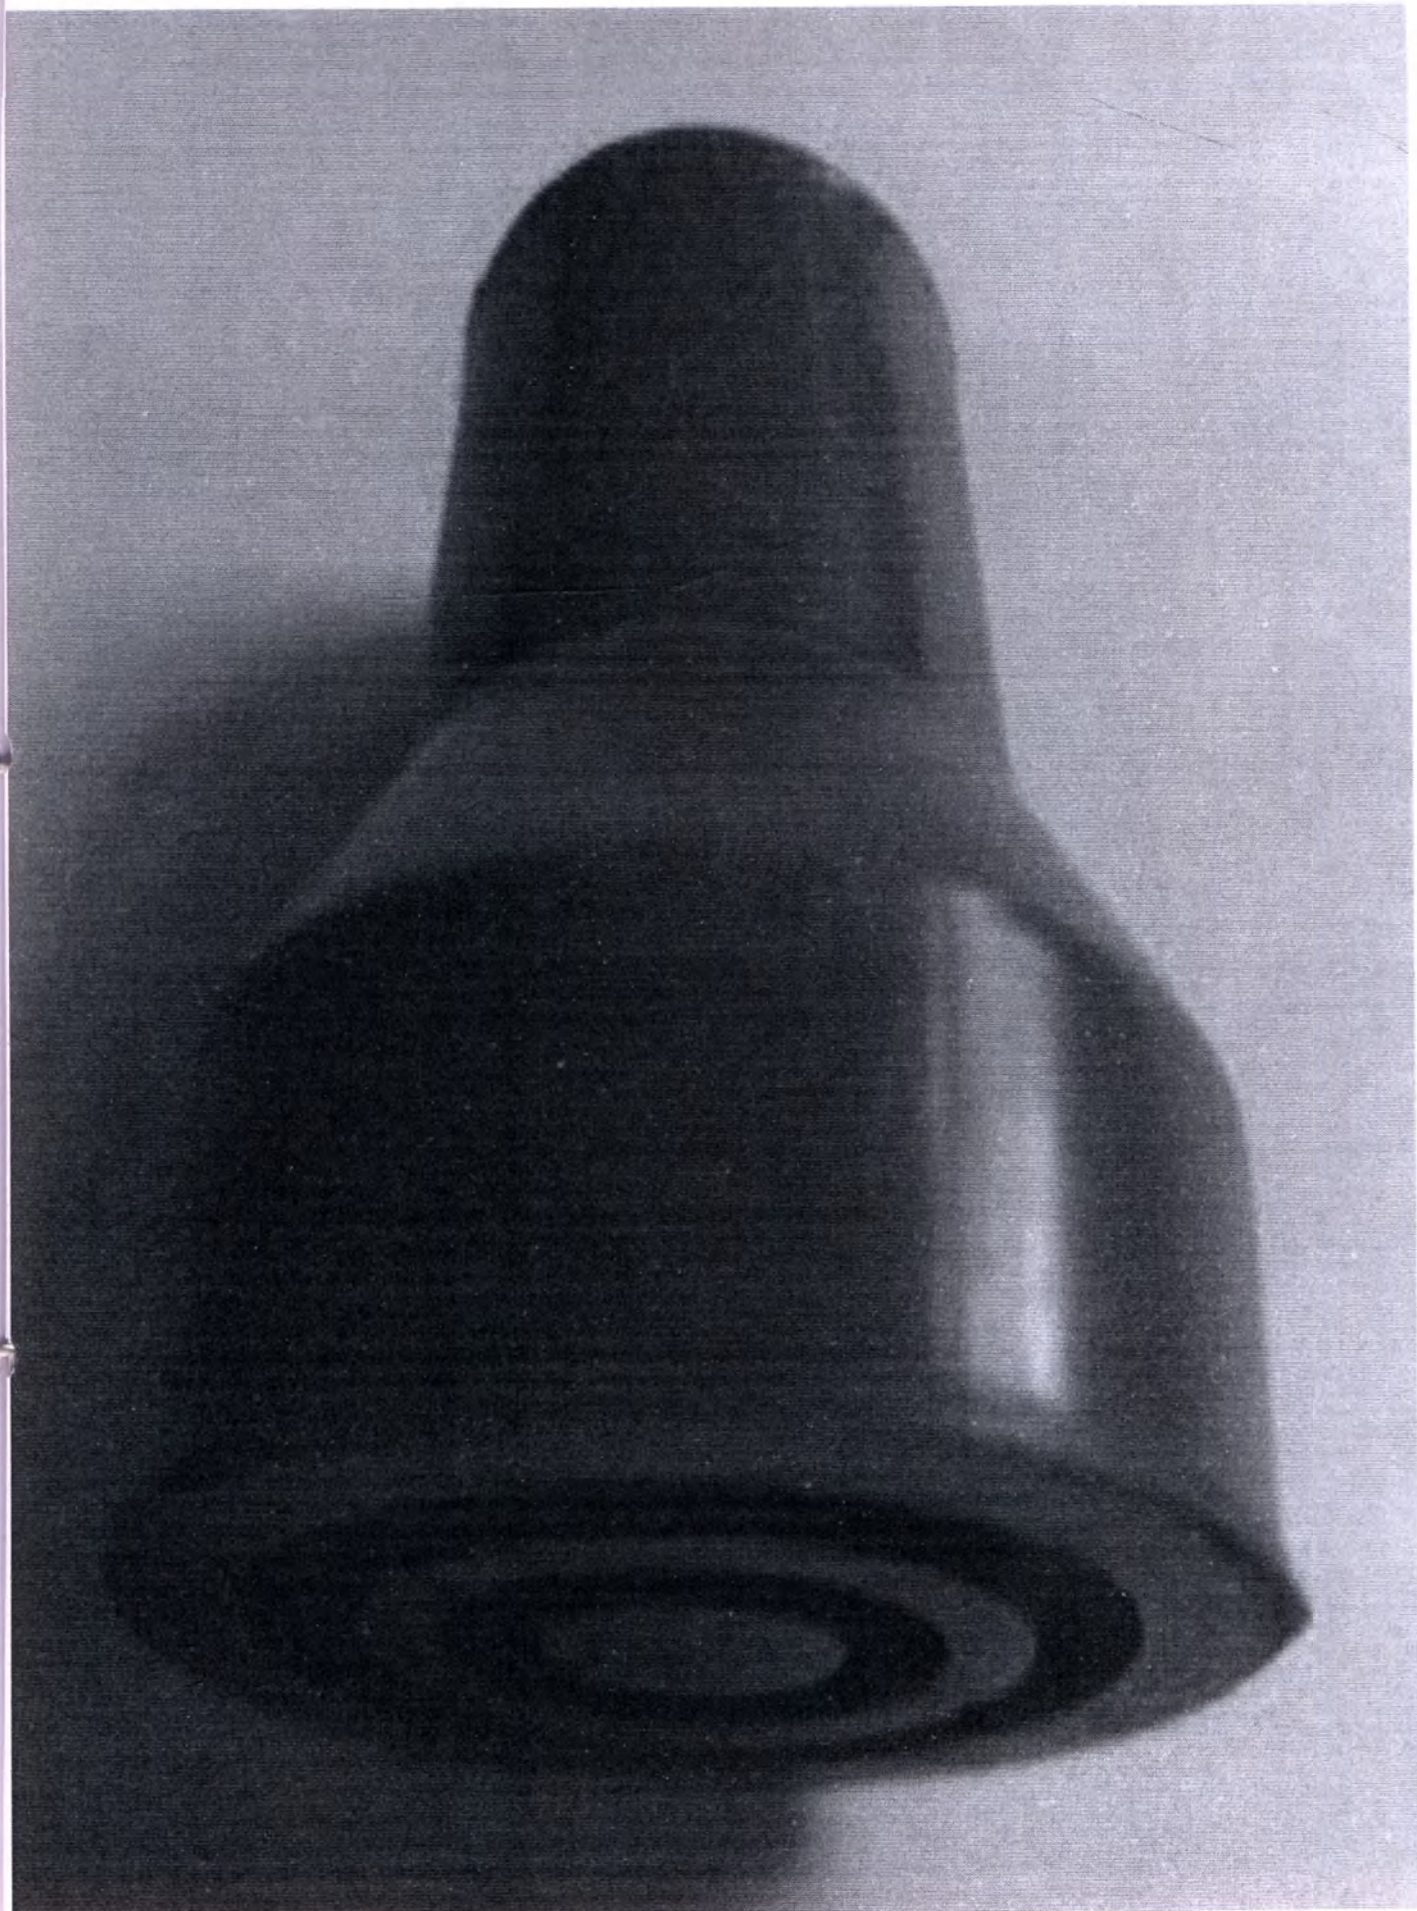


Рис. 24 – Наконечник, модель Т.Р016

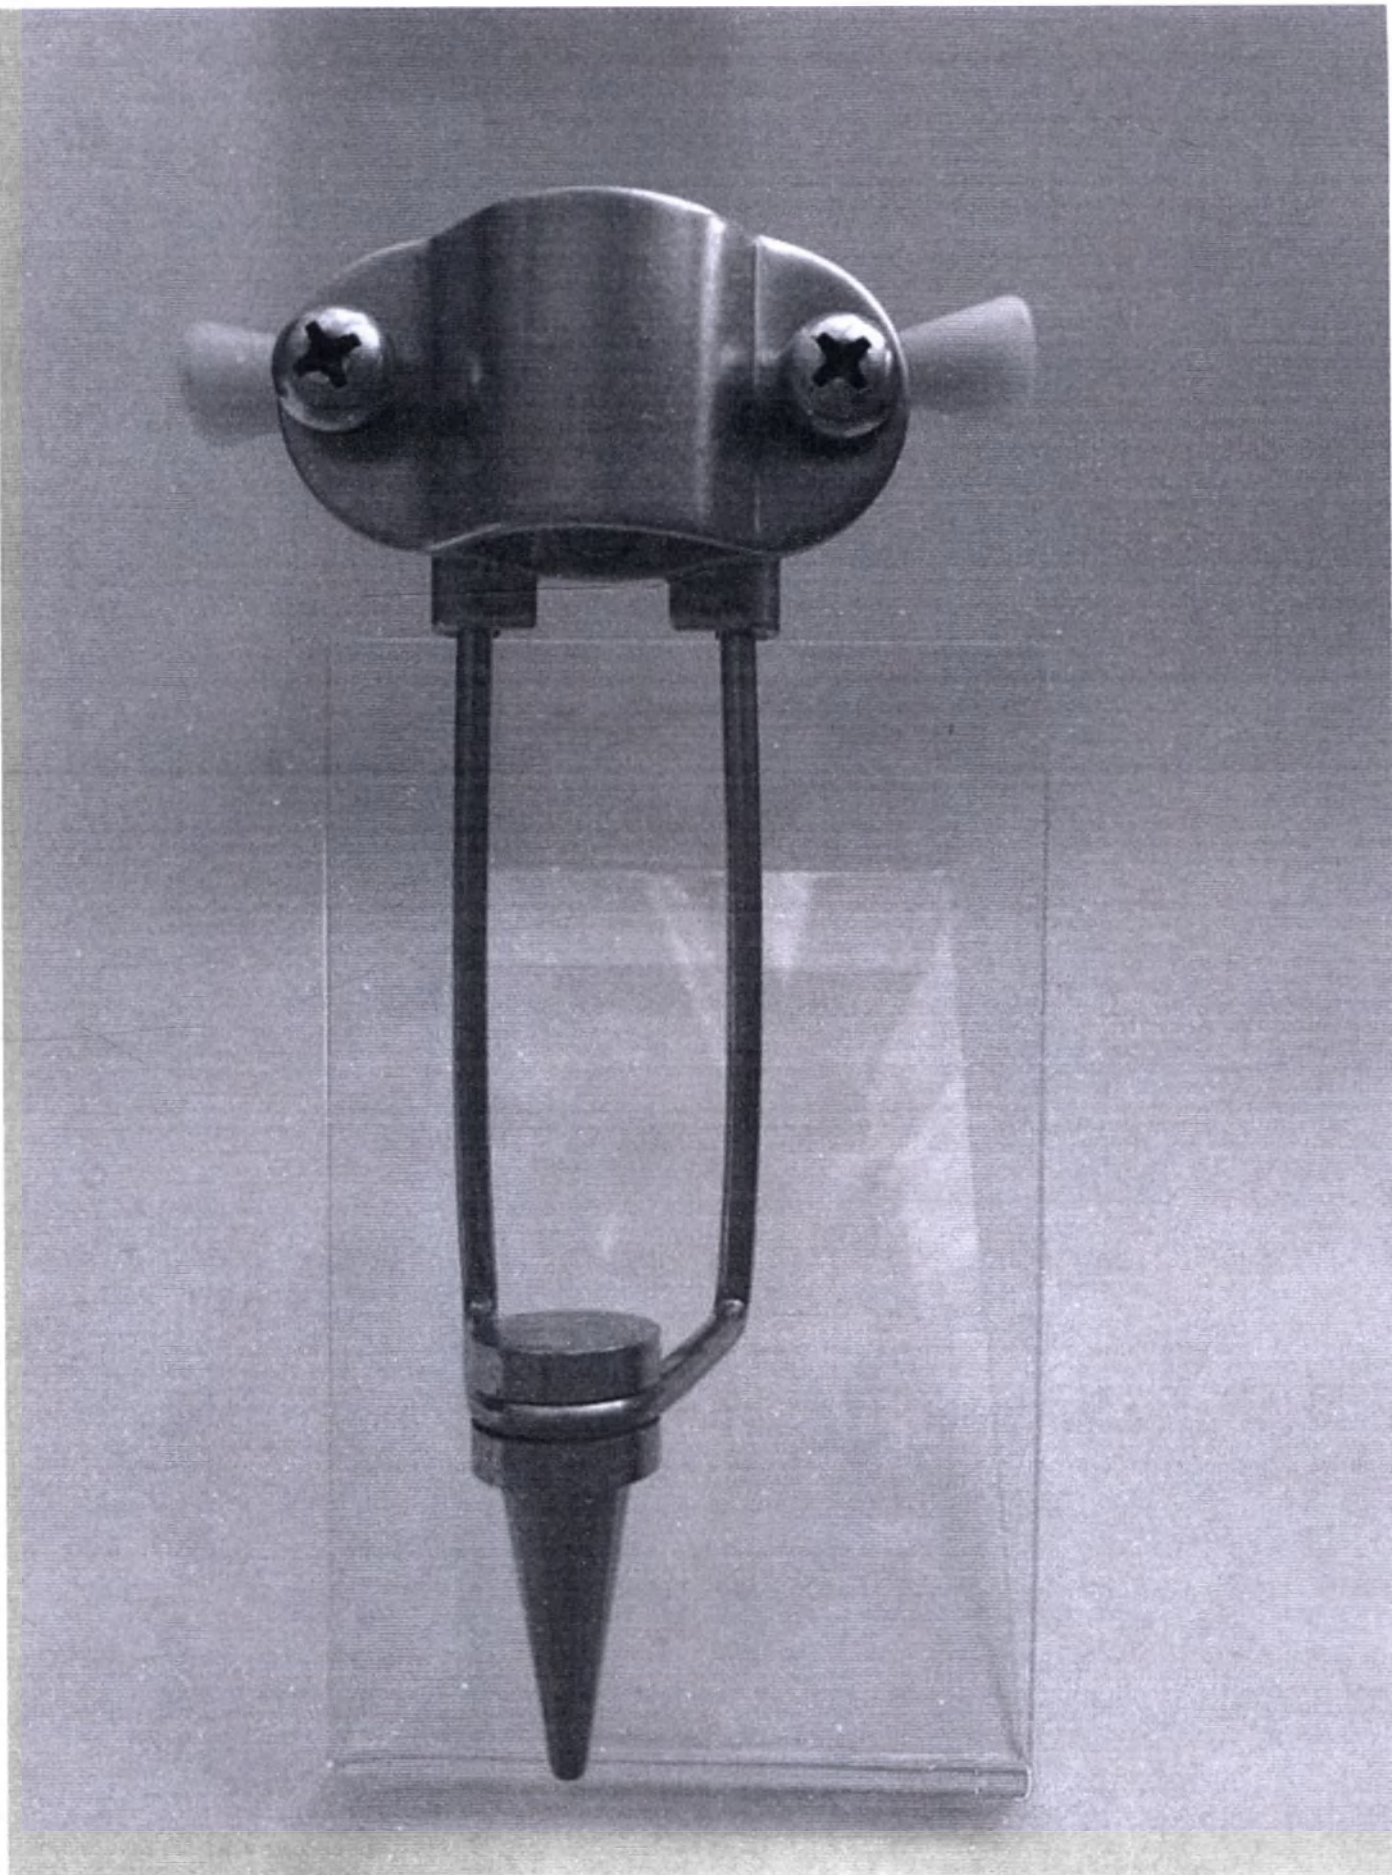


Рис. 25 – Устройство противоскольжения (УПС), модель Т.Р020

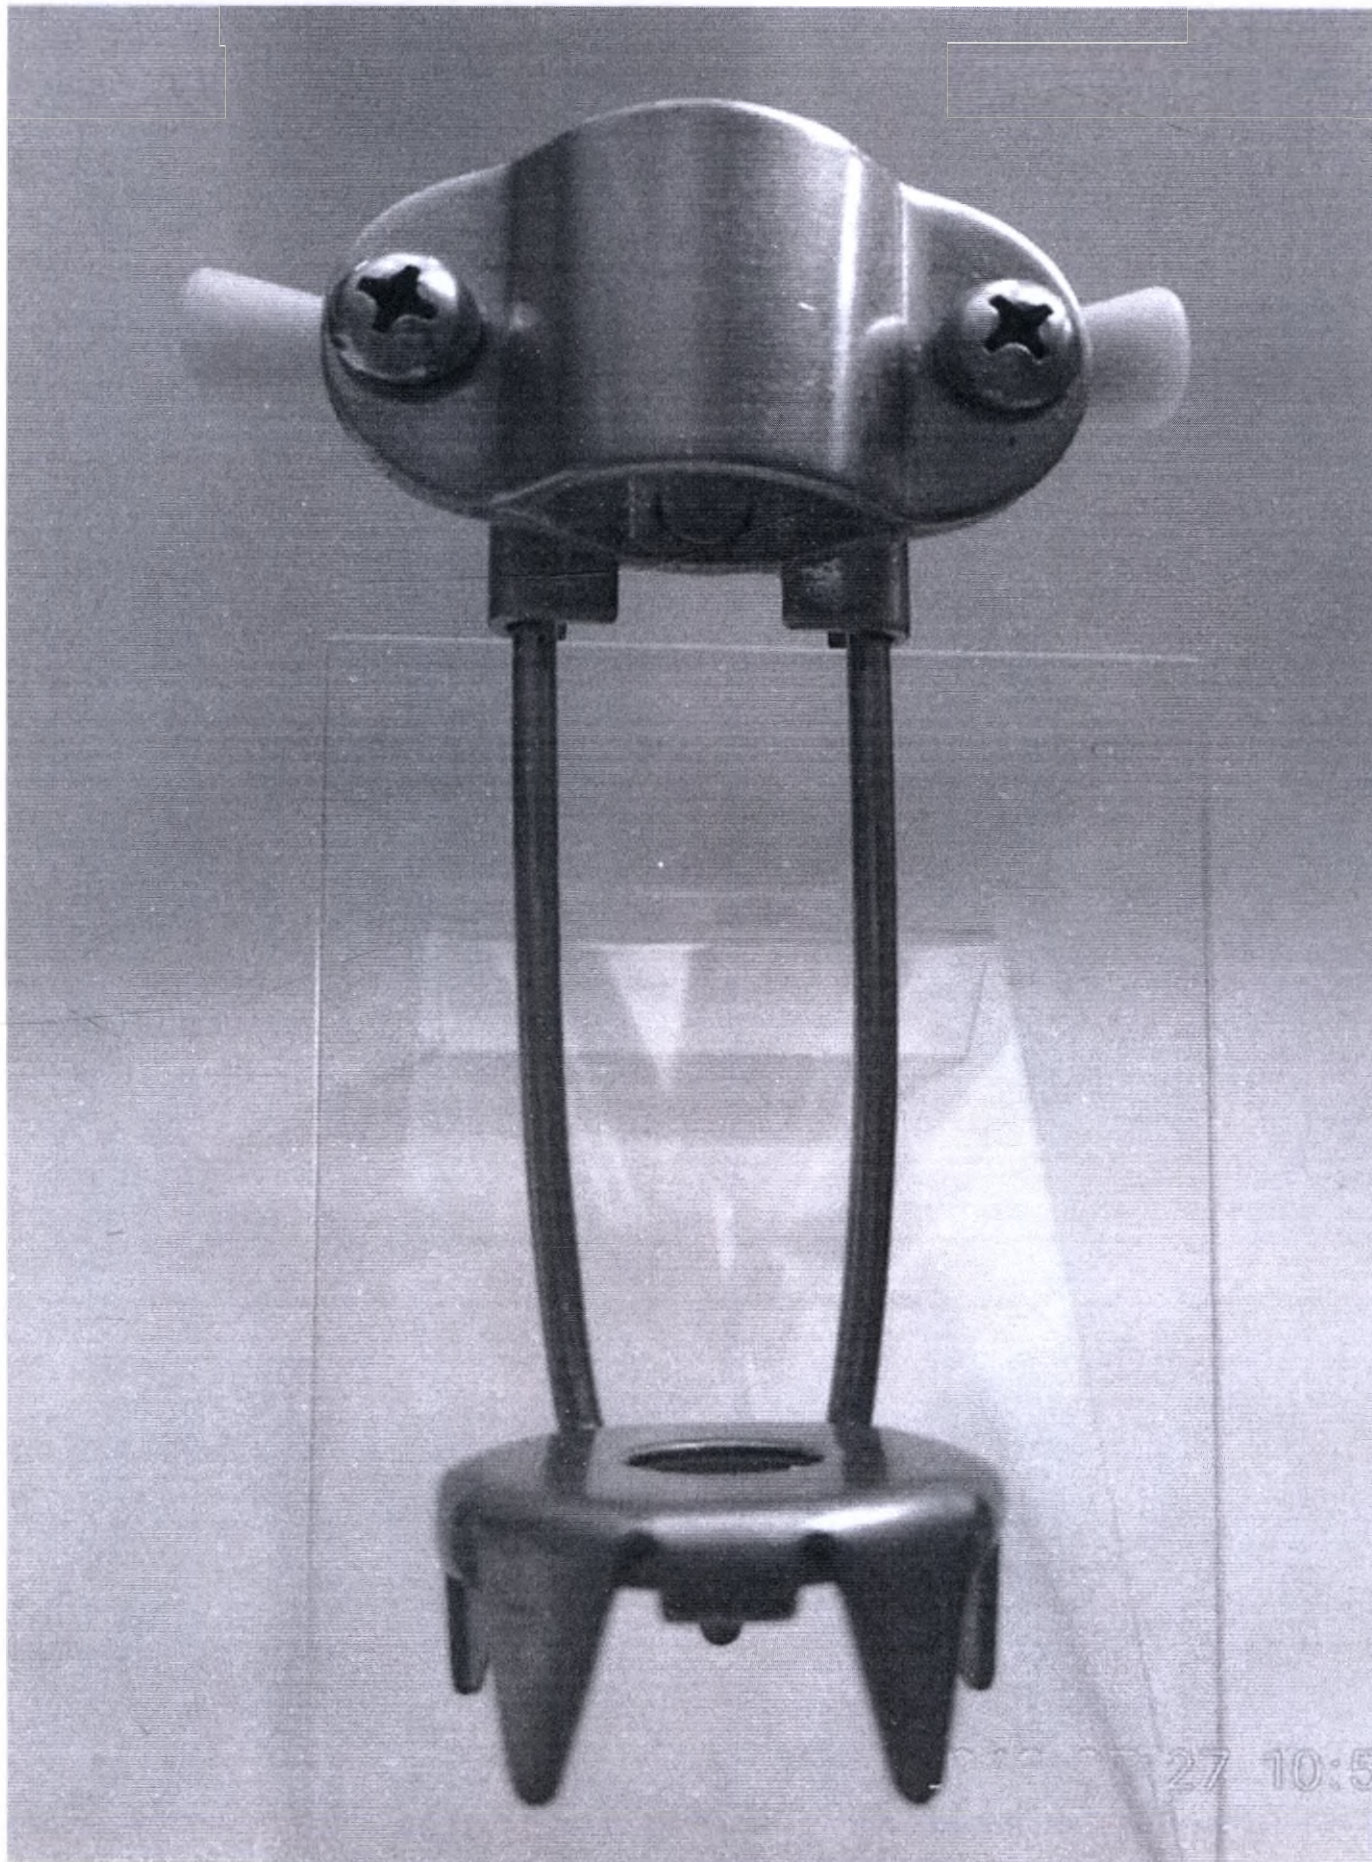


Рис. 26 – Устройство противоскольжения (УПС), модель Т.Р021



Рис. 27 – Валик подмышечный, модель Т.Р050

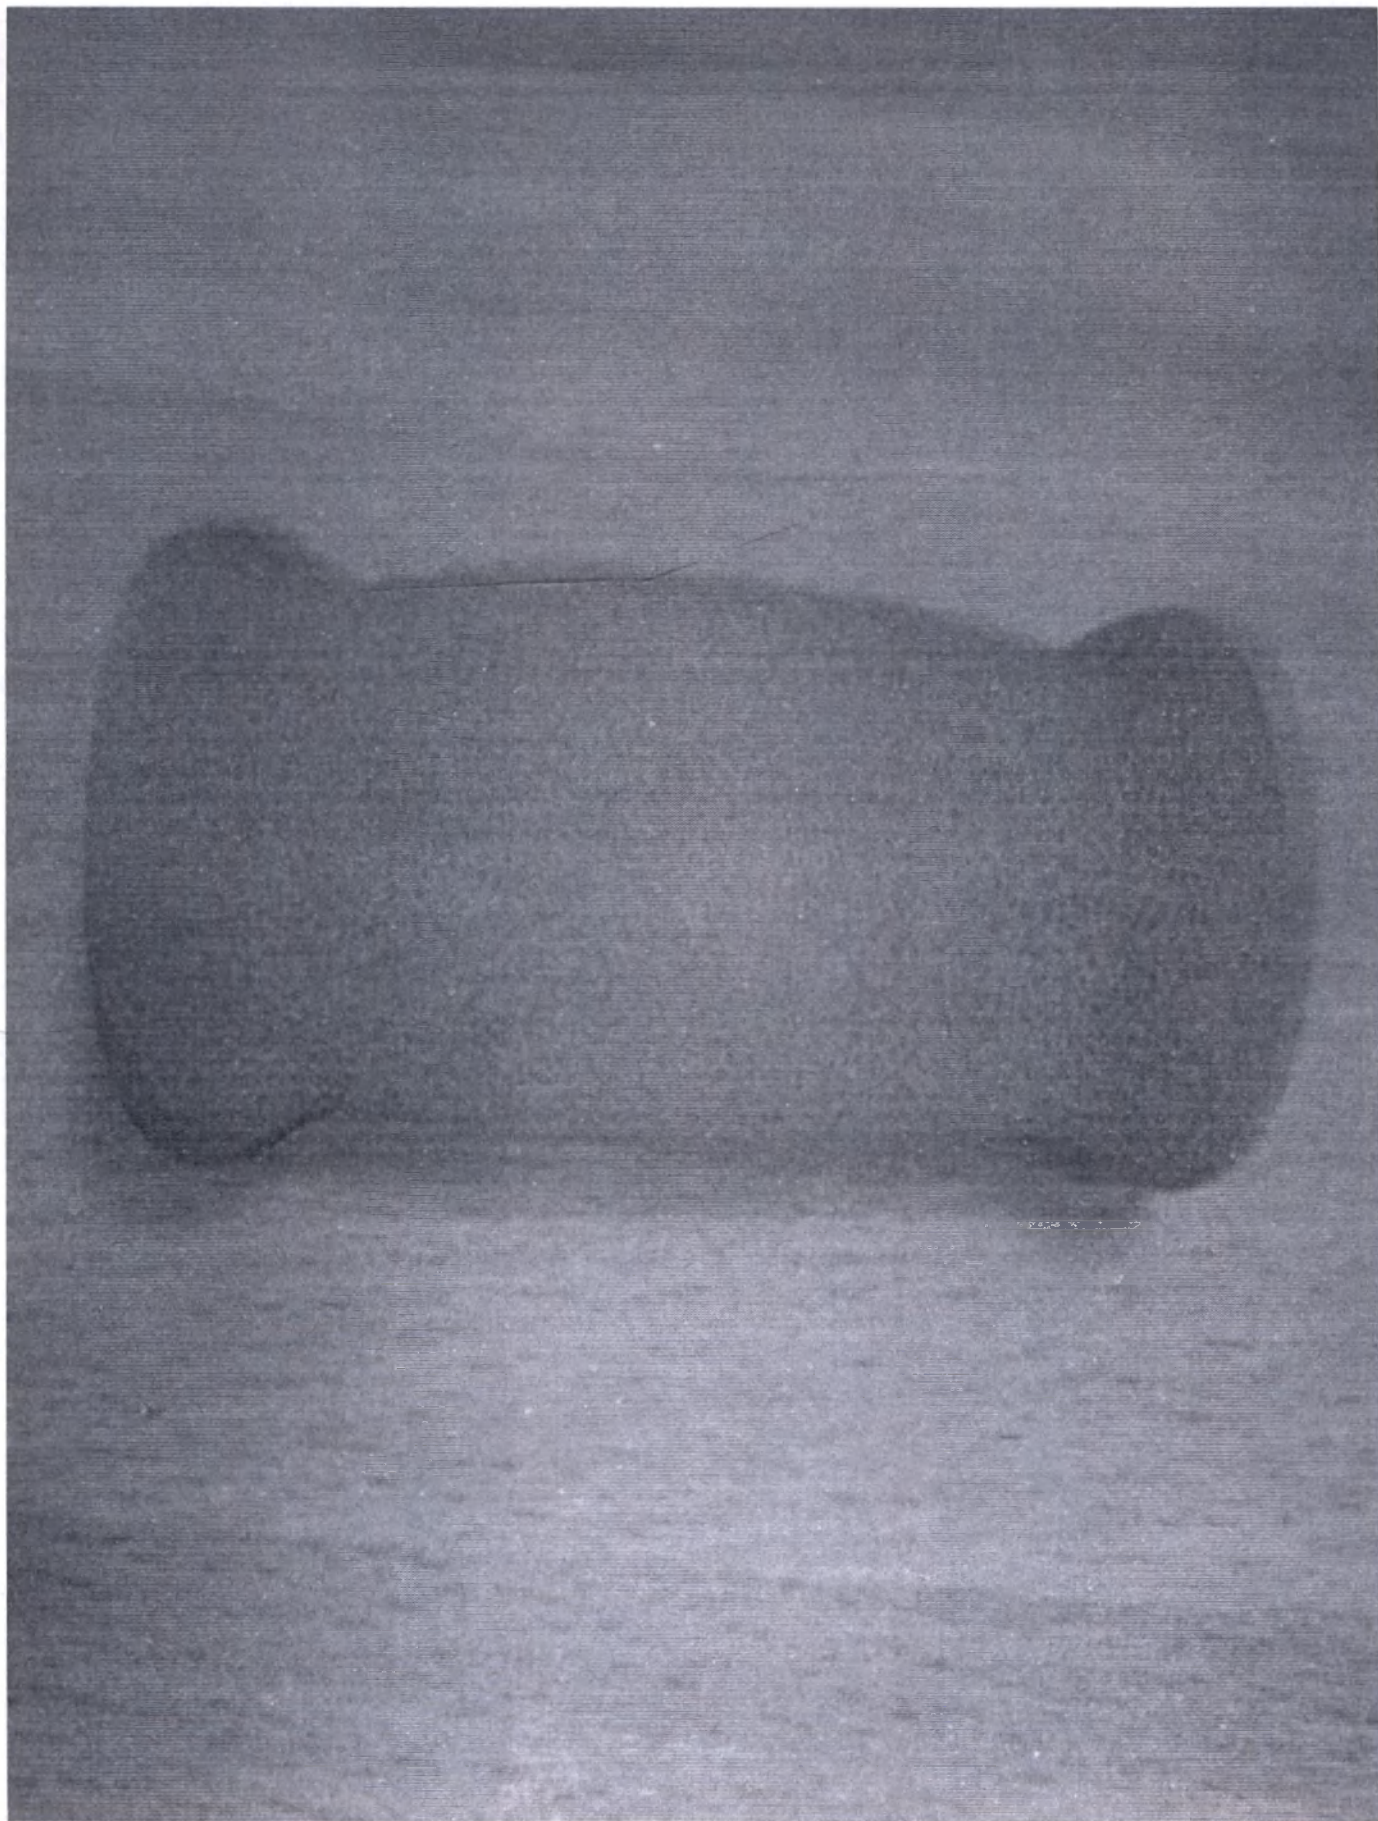


Рис. 28 – Рукоятка, модель Т.Р040

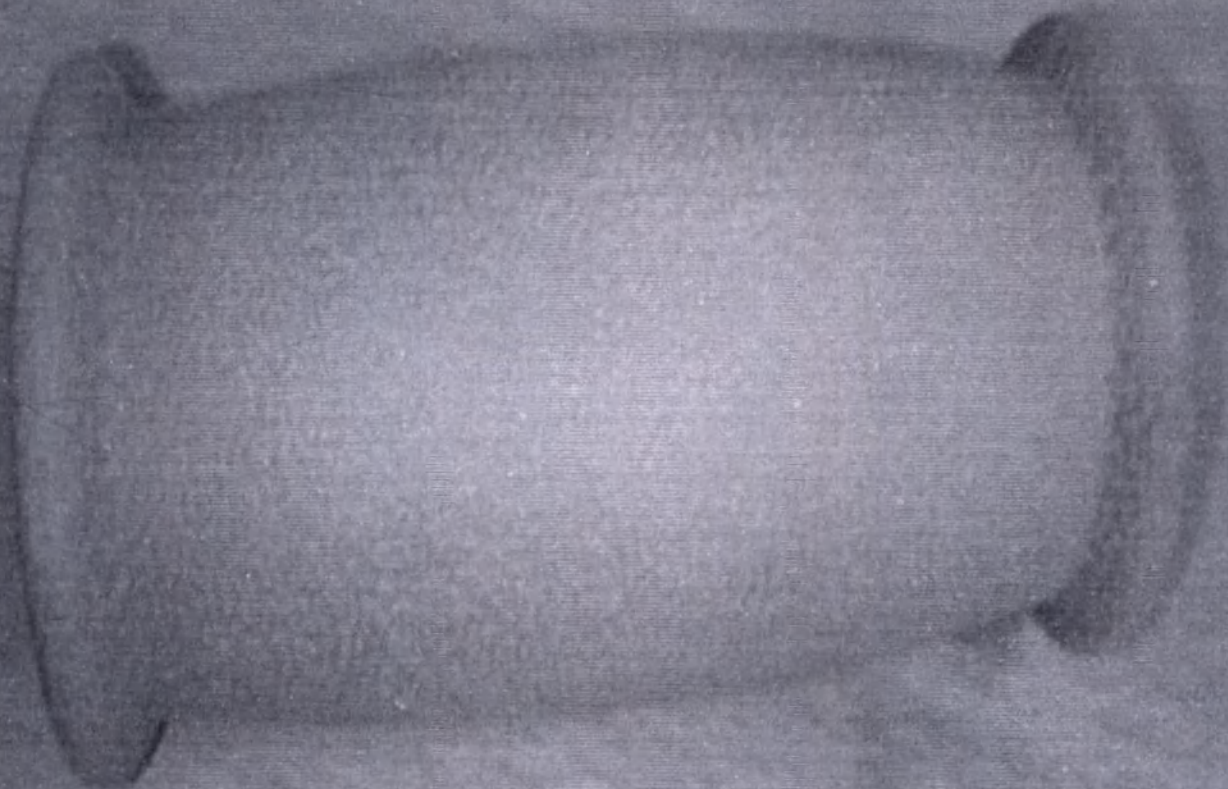


Рис. 29 – Рукоятка, модель Т.Р041

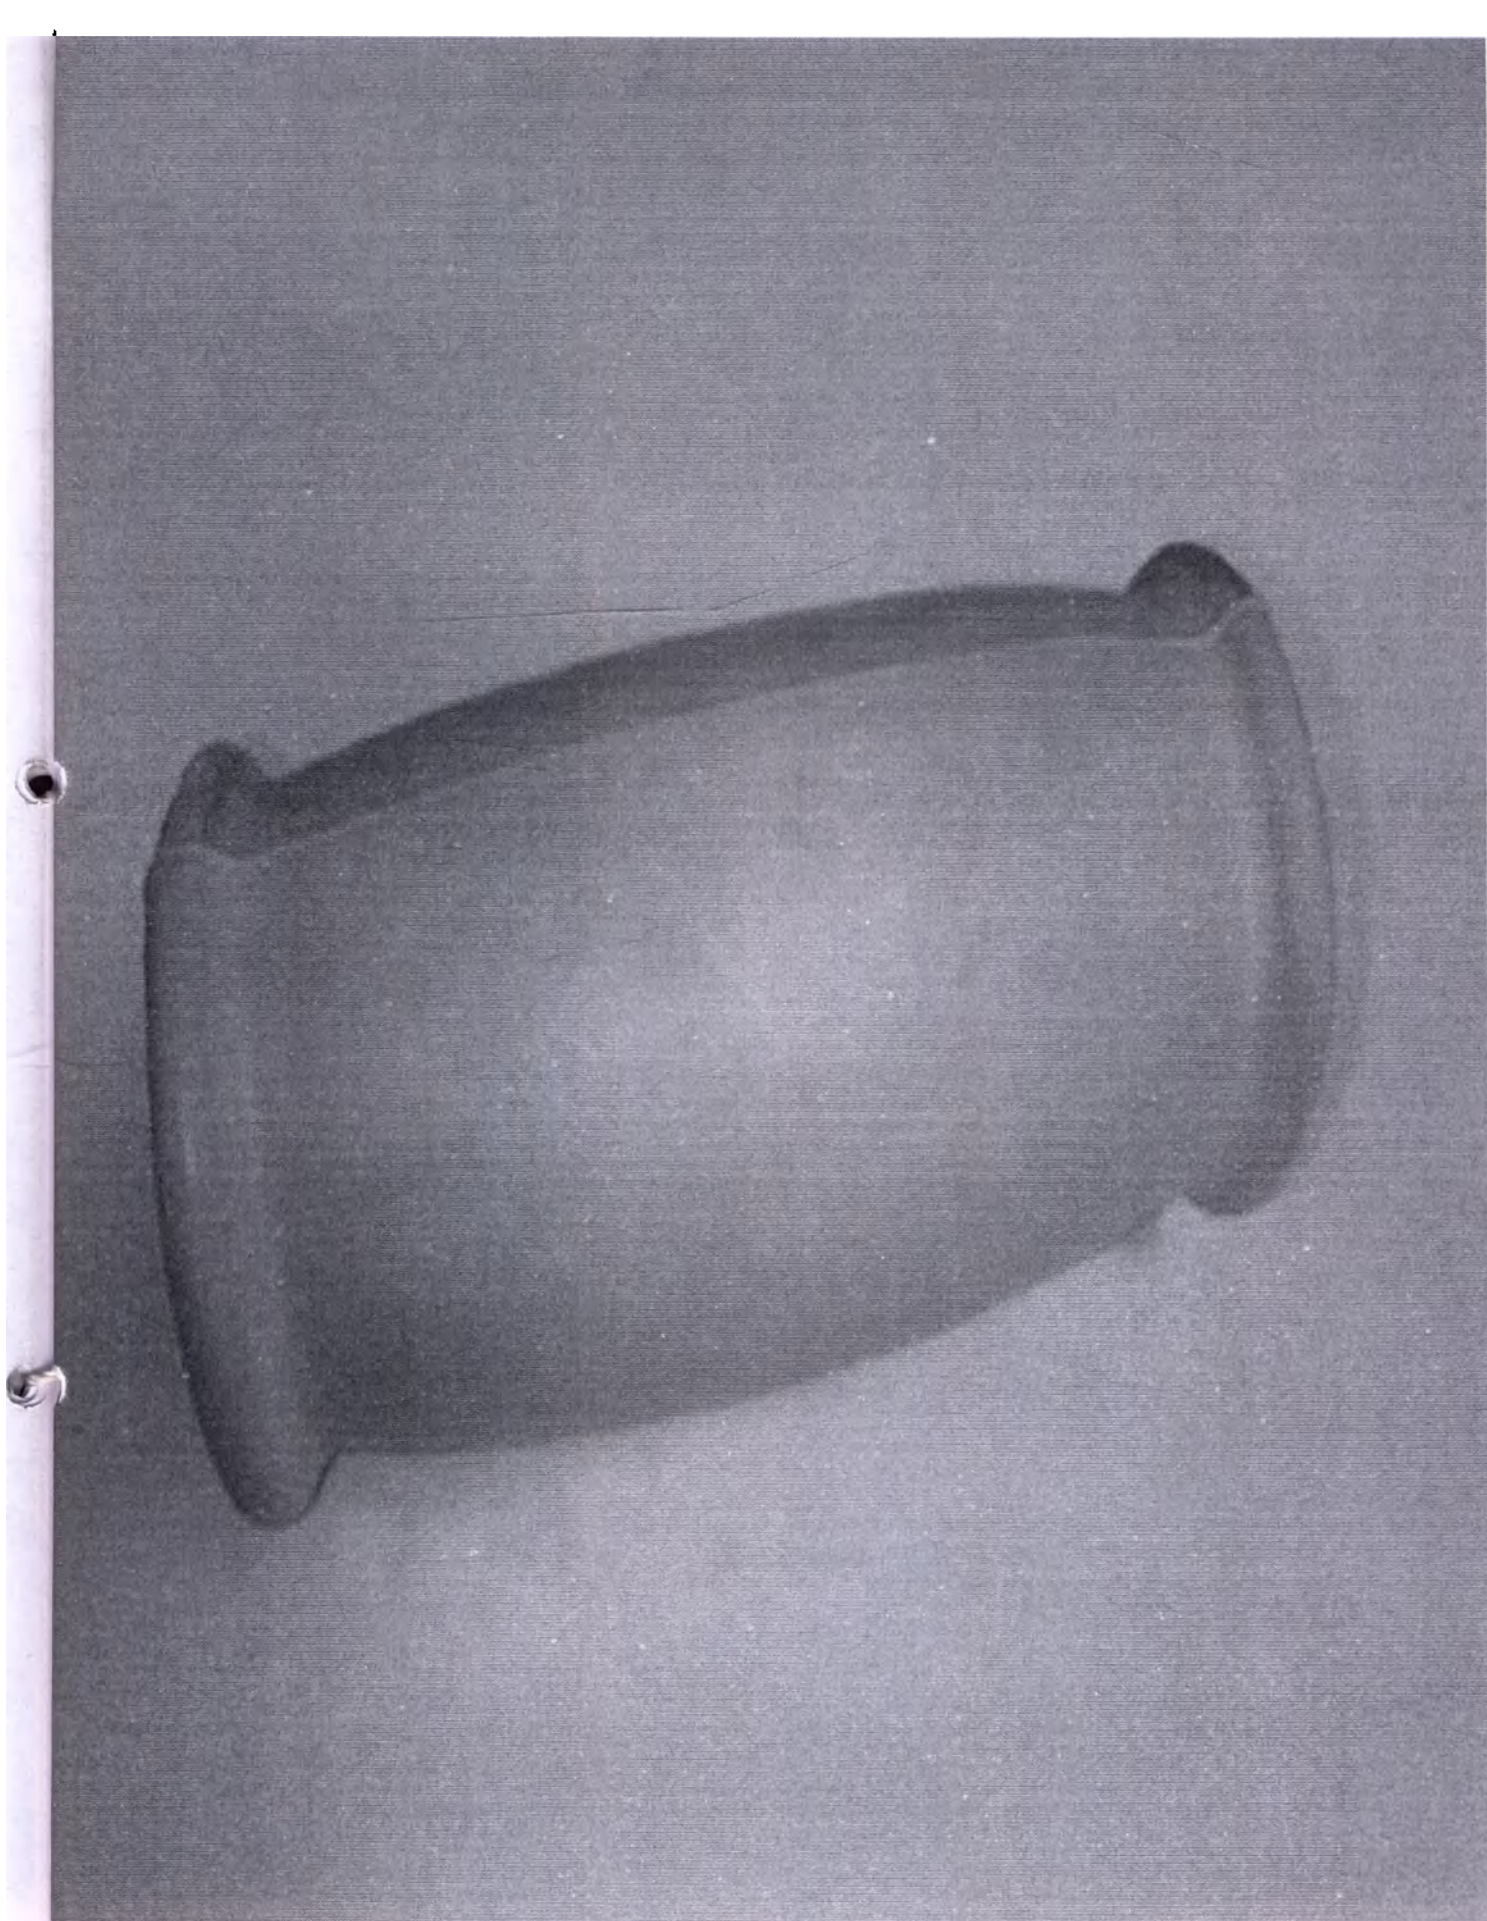


Рис. 30 – Рукоятка, модель Т.Р042

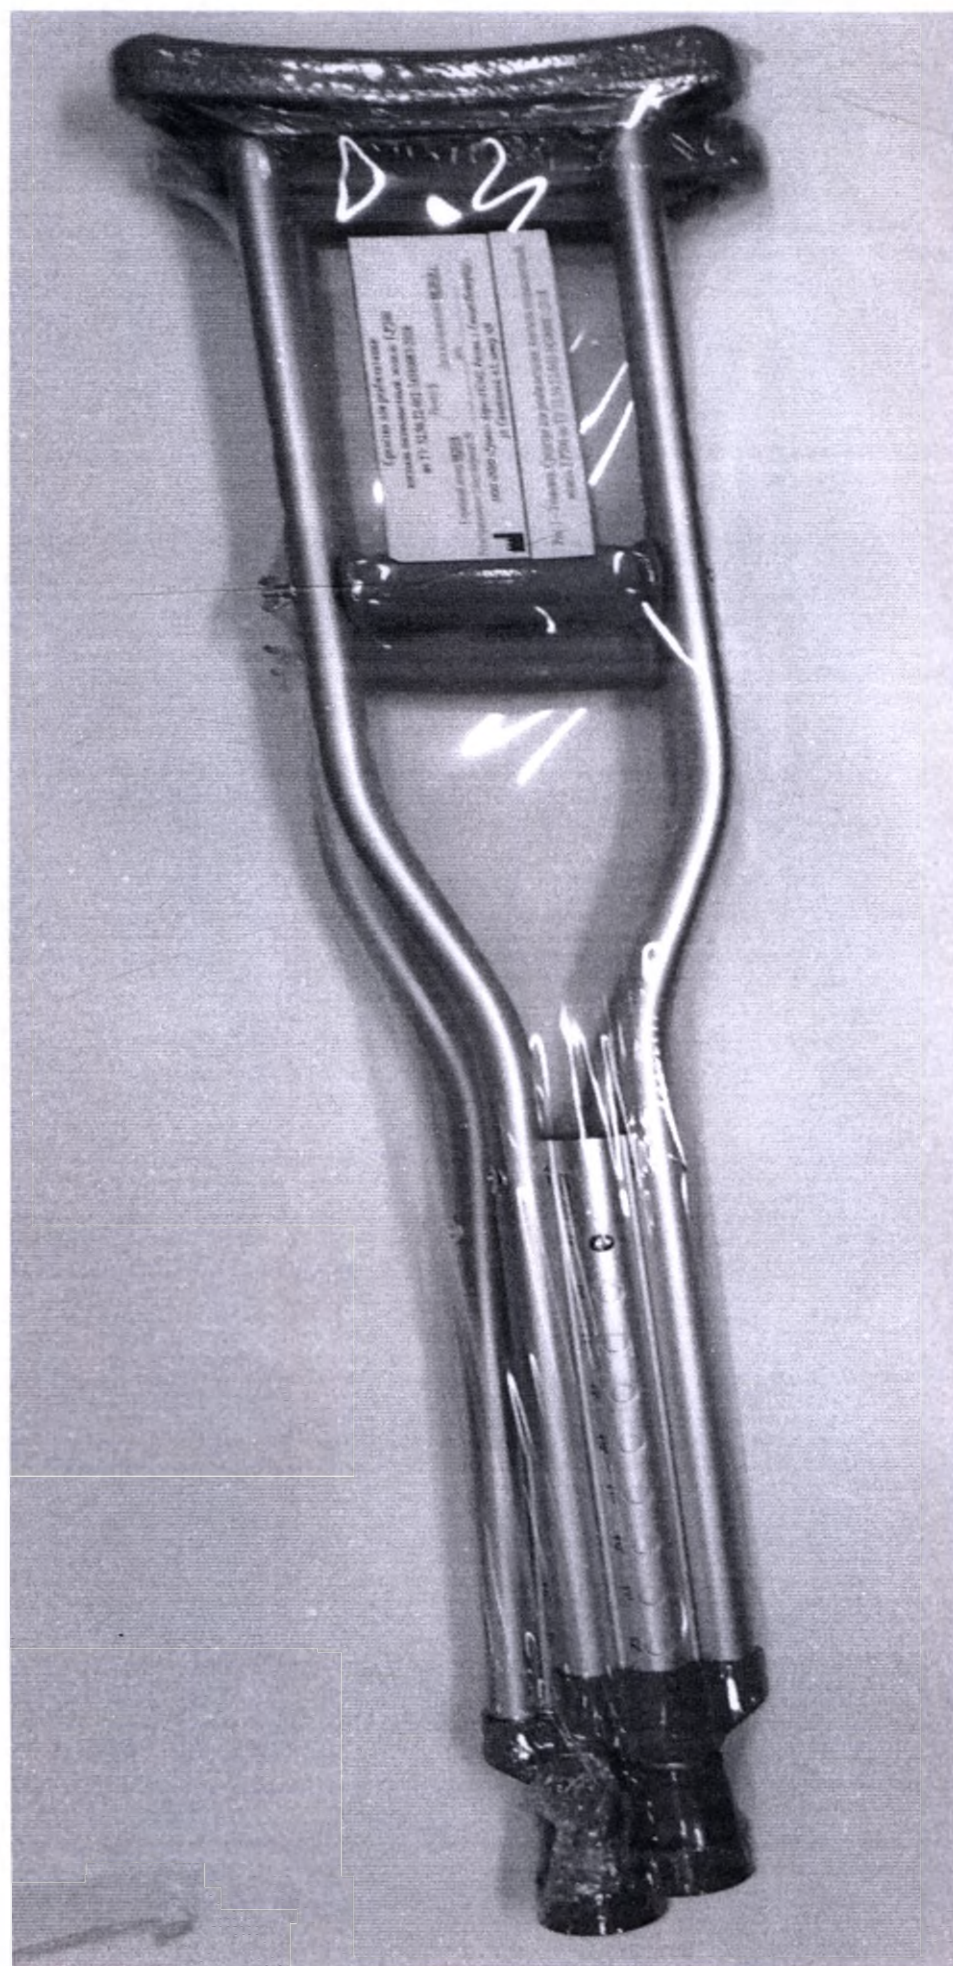


Рис. 31 – Упаковка. Средства для реабилитации: костыль подмышечный, модель Т.Р200 по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

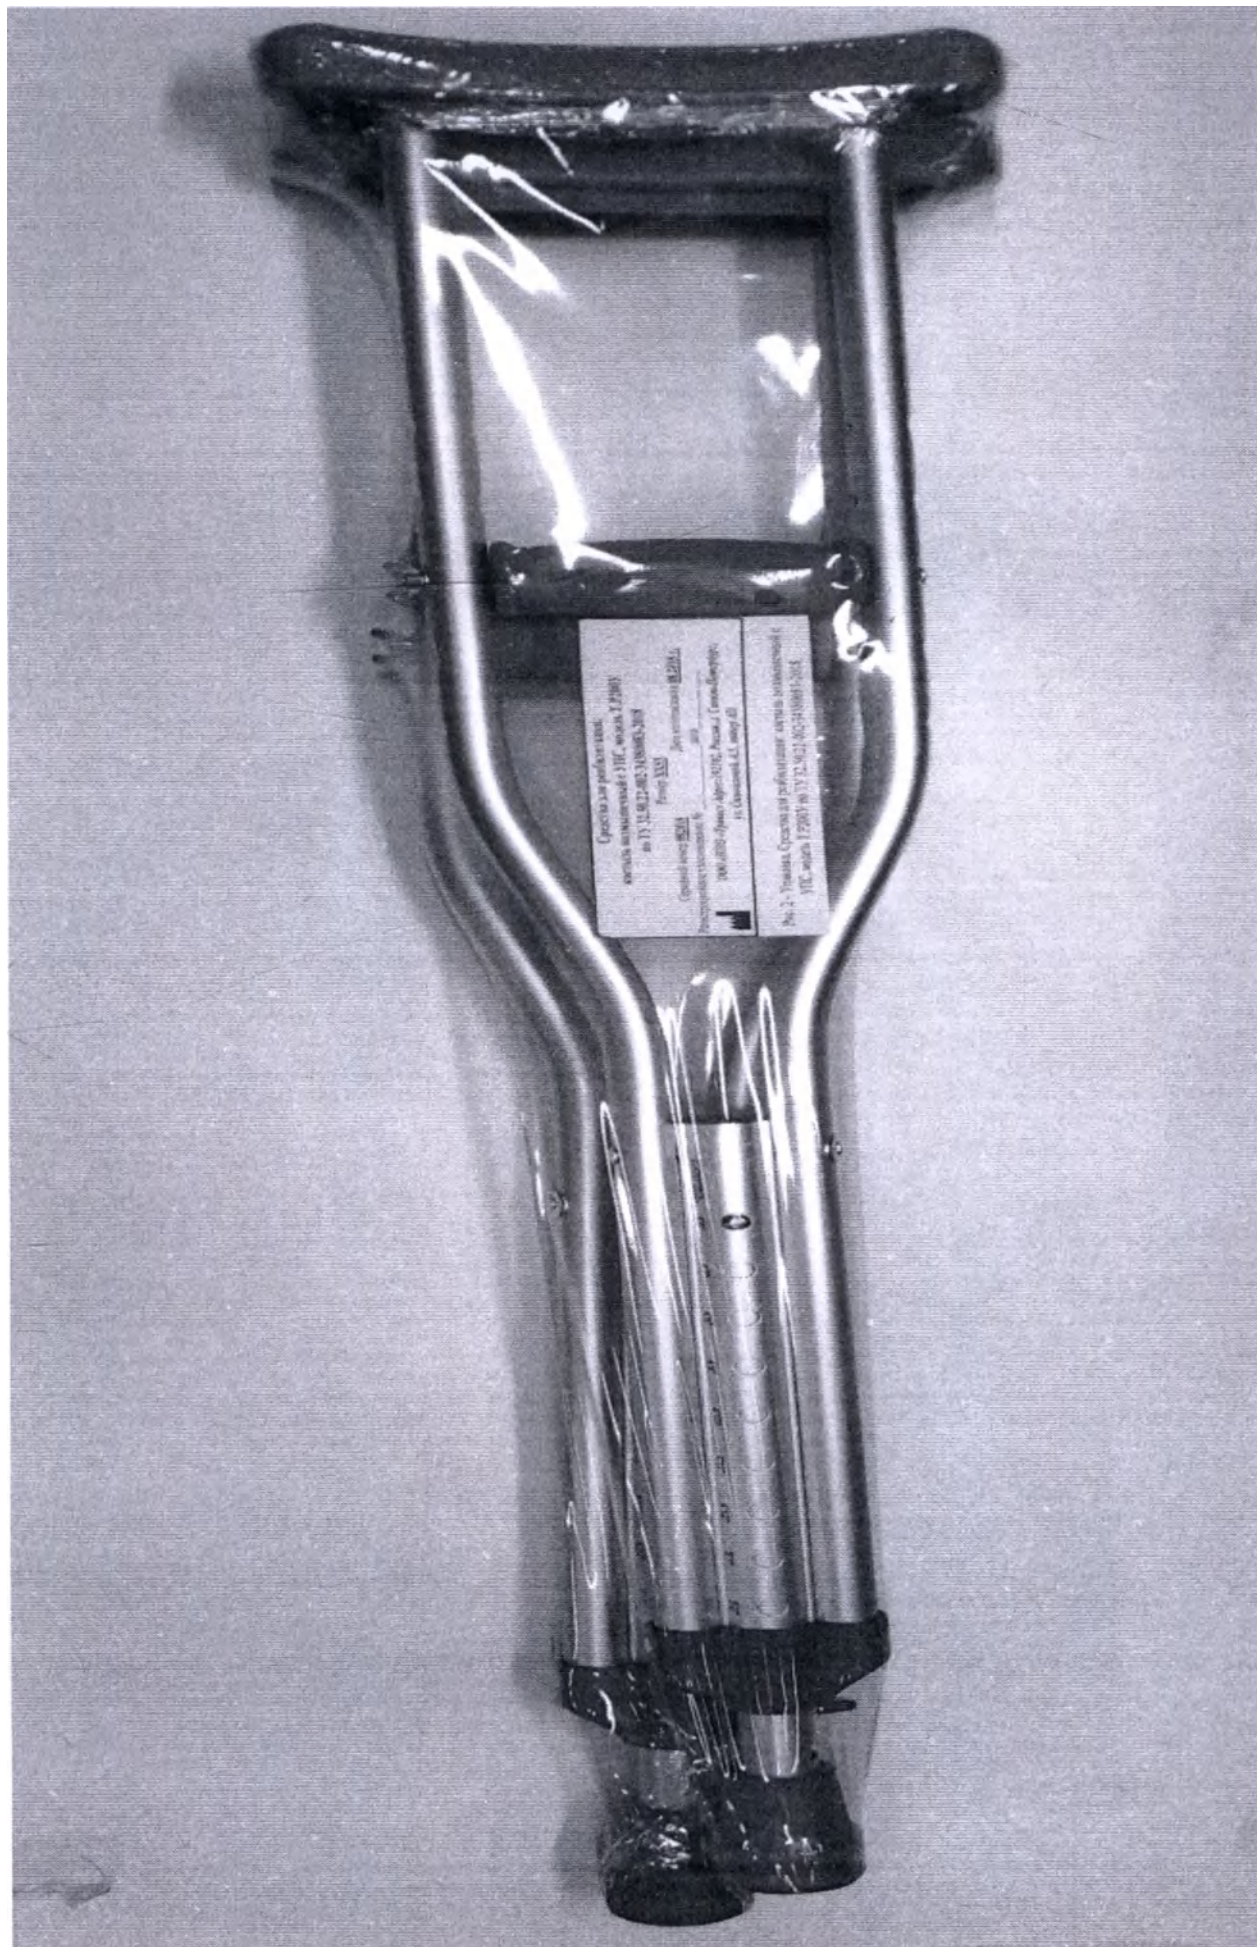


Рис. 32 – Упаковка. Средства для реабилитации: костыль подмышечный с УПС, модель Т.Р200У по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018



Рис. 33 – Упаковка. Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть, модель Т.Р220 по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

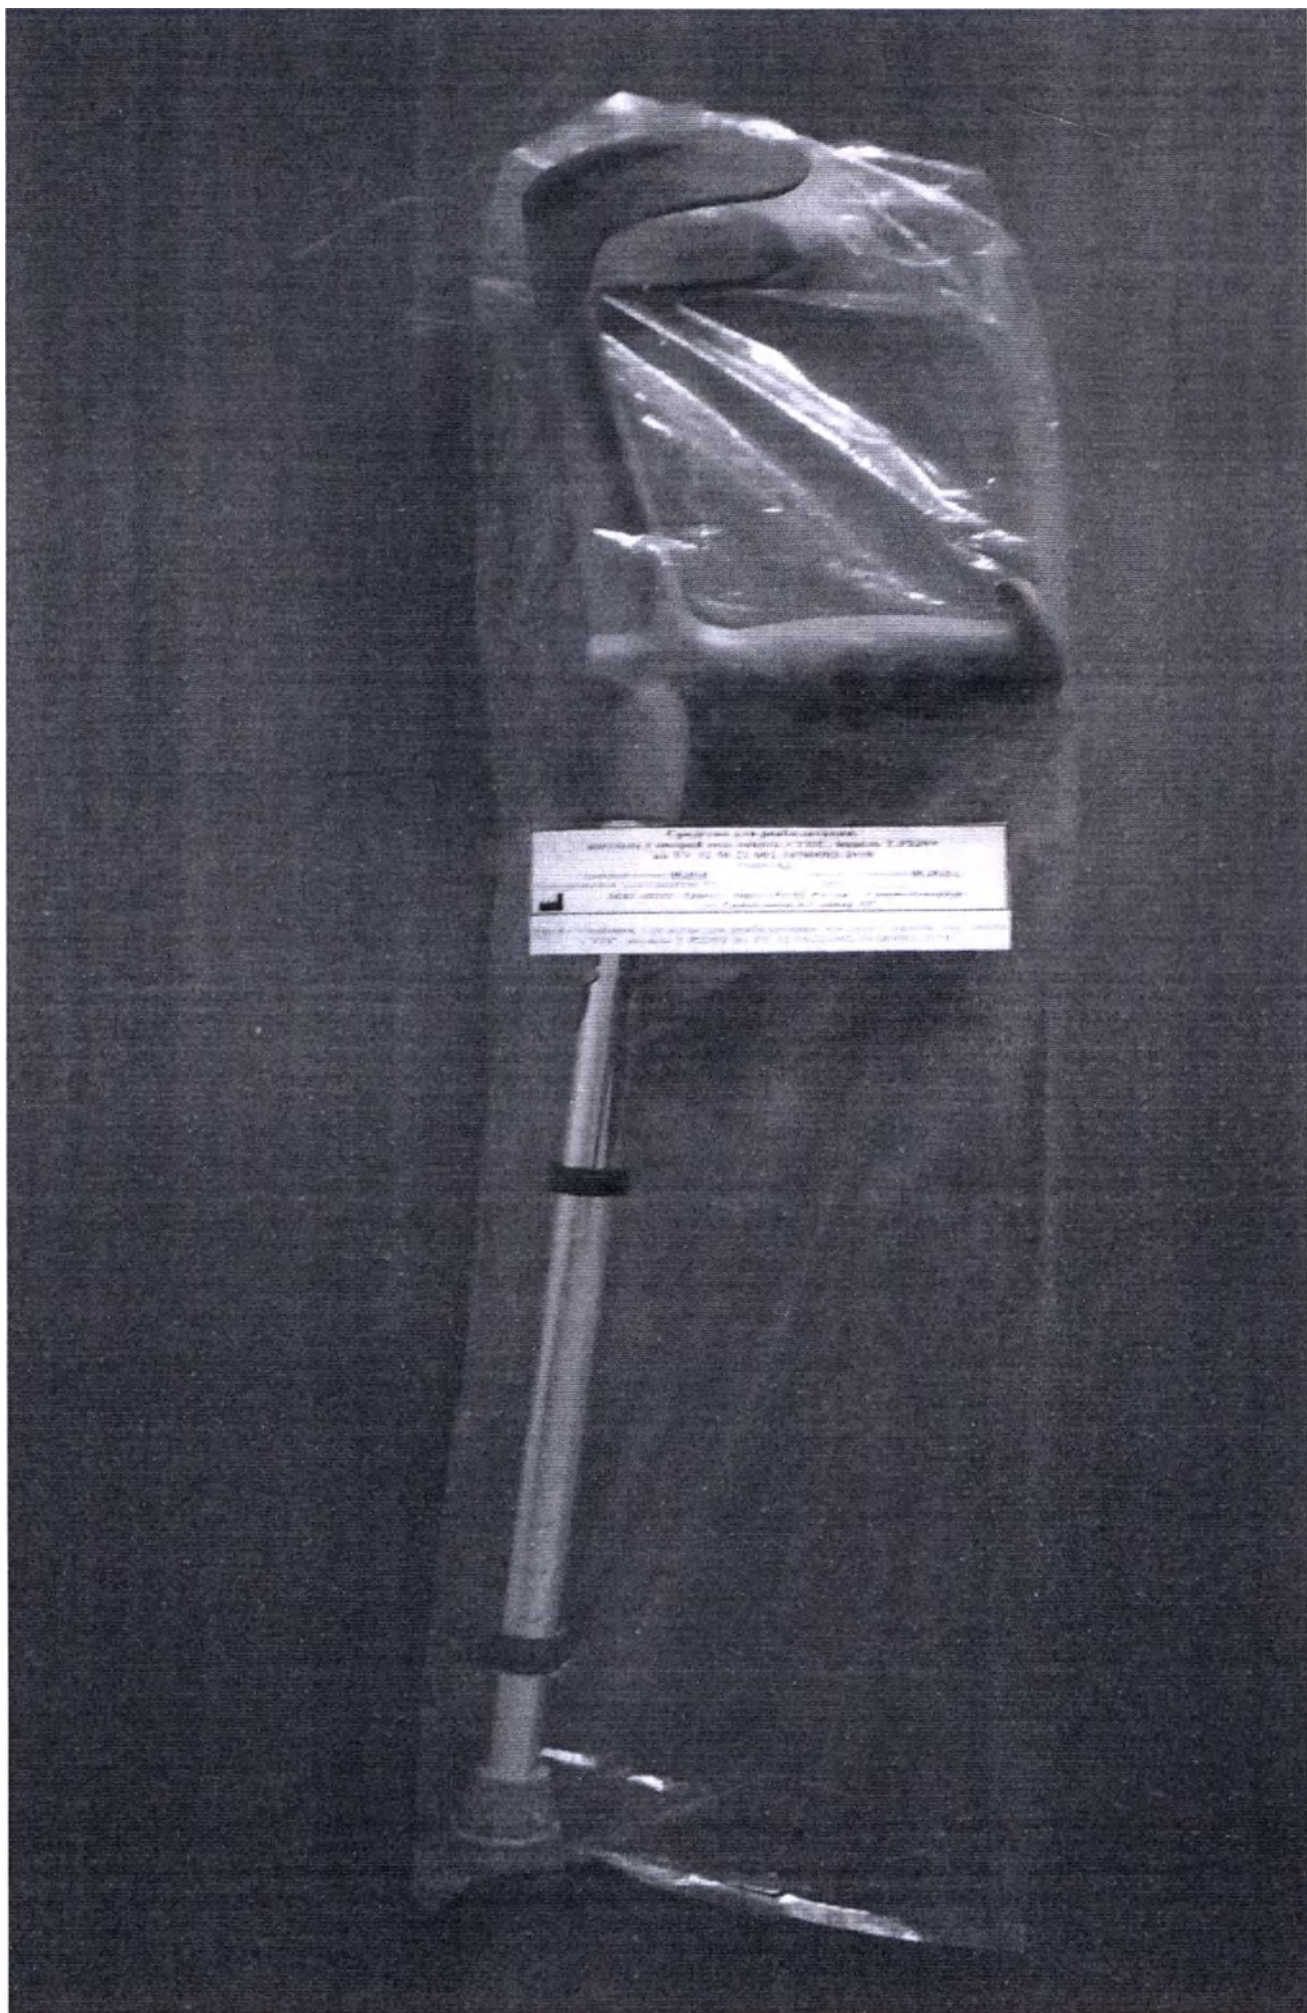


Рис. 34 – Упаковка. Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть с УПС, модель Т 20У по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

костыль подмышечный, модель Т.Р200

по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Размер **S**

Максимальная масса пользователя **150 кг**

Серийный номер **082018**

Дата изготовления **08.2018 г.**

Штрих-код

Регистрационное удостоверение №

дата

Рис. 35 – Маркировка. Средства для реабилитации: костыль подмышечный, модель Т.Р200 по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

костыль подмышечный с УПС, модель Т.Р200У

по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Размер **M**

Максимальная масса пользователя **150 кг**

Серийный номер **082018**

Дата изготовления **08.2018 г.**

Штрих-код

Регистрационное удостоверение №

дата

Рис. 36 – Маркировка. Средства для реабилитации: костыль подмышечный с УПС, модель Т.Р200У по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

костыль с опорой под локоть, модель Т.Р220

по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Размер **XXS1**

Максимальная масса пользователя **100 кг**

Серийный номер **082018**

Дата изготовления **08.2018 г.**

Штрих-код

Регистрационное удостоверение №

дата

Рис. 37 – Маркировка. Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть, модель Т.Р220 по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

ООО «НПО «Тривес»

Средства для реабилитации:

костыль с опорой под локоть с УПС, модель Т.Р220У

по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Размер **L1**

Максимальная масса пользователя **100 кг**

Серийный номер **082018**


Дата изготовления **08.2018 г.**

Штрих-код

Регистрационное удостоверение №

дата

Рис. 38 – Маркировка. Средства для реабилитации: костыль с опорой под локоть с УПС, модель Т.Р220У по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

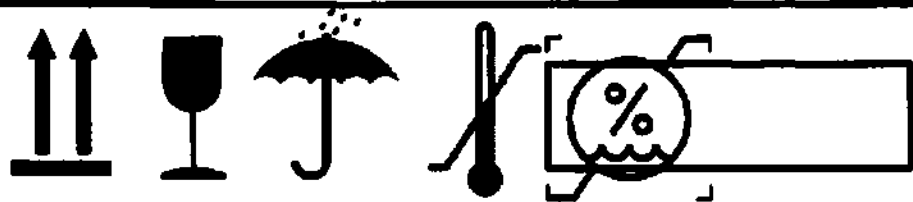

Средства для реабилитации: костыли по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Дата упаковывания _____ Количество изделий _____ шт.

Грузополучатель: _____
Пункт назначения: _____
Пункт перегрузки: _____

____ × ____ × ____ см	Брутто – ____ кг	 ООО «НПО «Тригес» Адрес: 192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, литер АП
	Нетто – ____ кг	

Рис.39 - Маркировка транспортной упаковки. Средства для реабилитации: костыли по ТУ 32.50.22-002-34380083-2018

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

37 (тридцать семь) листов

Директор

ООО «НПО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

« »

20

г.

