

Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антител IgG / IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «ИМБИАН-SARS-CoV-2 IgG/IgM ИХА», ТУ 21.20.23-002-41390295-2021, серия № 010321, серия № 150321

Комплект №1 серия № 010321 от 01.03.2021 г.



«ИМБИАН-SARS-CoV-2 IgG/IgM ИХА»
Комплект №1

Набор реагентов «Тест-система» включает реагенты для иммунохимического анализа сыворотки крови на наличие антител IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах сыворотки, плазмы и/или цельной крови человека «ИМБИАН-SARS-CoV-2 IgG/IgM ИХА».

ГТУ 21.20.22-001-4198995-2017,
серия № 010711, серия № 150321
ГТУ № XXX XXXXXXXX

LOT 150321
REF KRL-002/1
EXP 15-03-2021
EXP 15-03-2023

Набор реагентов содержит:
1 Тест-кассета 1 шт
2 Бутылочка сыворотки 1 шт
3 Одноразовая палочка 1 шт
4 Салфетка спиртовая 1 шт
5 Салфетка стерильная 1 шт

Для хранения и транспортировки
не замораживать.

2°C-30°C

ИВД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630659, Новосибирская область, г. Я.
Хангалов, ул. Свободы, д. 27
8-800-600-90-77, 8-383-309-34-84, info@imbian.ru

«ИМБИАН-SARS-CoV-2 IgG/IgM ИХА»
Тест-кассета
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT 150321
EXP 15-03-2023 2°C-30°C

ИВД



Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
65*56 мм
только для наружного применения


СОСТАВ: салфетка из нетканого, дезинфицирующая композиция (75% этиловый спирт, 5% когиритовый спирт, 20% дистиллированная вода).

Антисептическая эффективность подтверждена исследованием ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора от 17.12.2019 г.

ИНЕКТА





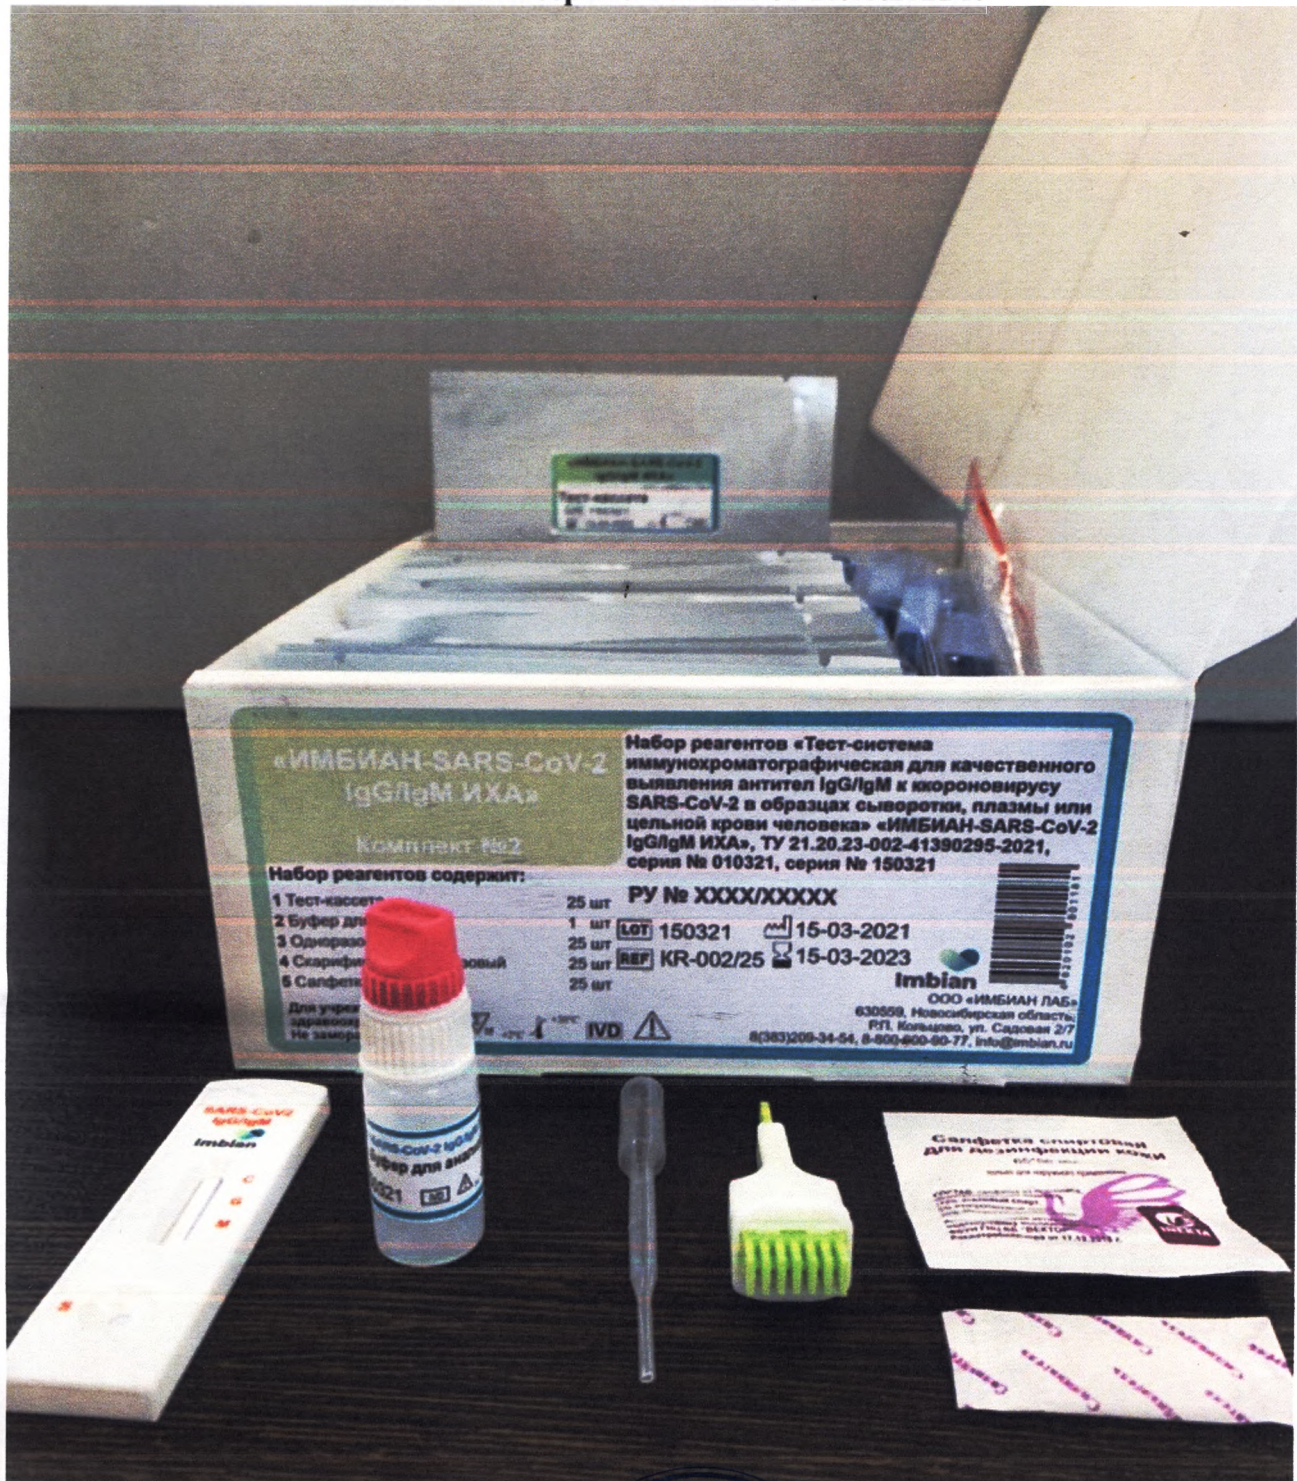

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 2

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2021 г

