




ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Установка для обезвреживания медицинских отходов «БАЛТНЕР II», Исполнение БАЛТНЕР II –100 некст











УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ "БАЛТНЕР II-100"



- готов к работе
- нагрев
- дезинфекция
- вакуум
- завершение цикла
- высокий
- низкий

МОДУЛЬ 2


МОДУЛЬ 1

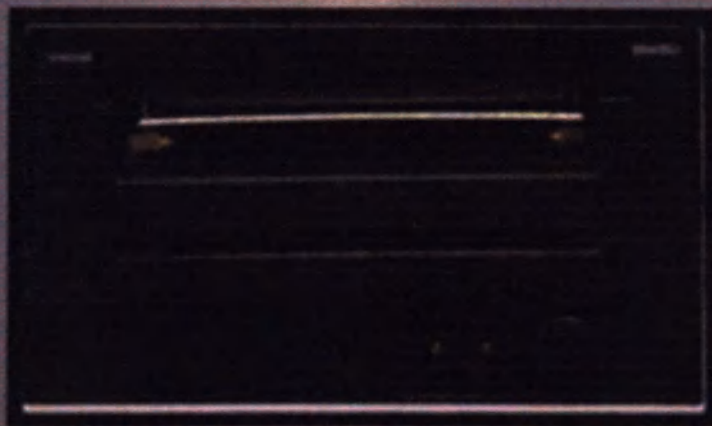

ВНИМАНИЕ!
При работе с оборудованием
необходимо ознакомиться
с инструкцией по эксплуатации.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
открывать крышку при подключенном
силовом кабеле к электрической сети.

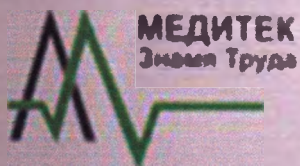

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ "БАЛТНЕР II-100 НЕКСТ"




- готов к работе
- нагрев
- дезинфекция
- вакуум
- завершение цикла
- высокий
- низкий

МОДУЛЬ 2



МОДУЛЬ 1



ВНИМАНИЕ!
При работе с оборудованием
необходимо ознакомиться
с инструкцией по эксплуатации.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
открывать крышку при подключенном
силовом кабеле к электрической сети.



Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью:

7 (семь) листов

Дата _____.20__ г.

Генеральный директор ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»


Крупницкий Д.Е.




РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР II»

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
"БАЛТНЕР II" ВСЕХ ИСПОЛНЕНИЙ.

БАЛТНЕР II 15

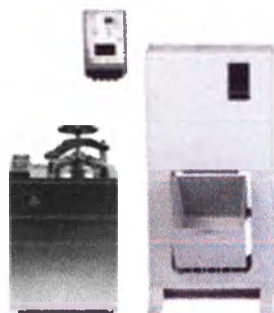


БАЛТНЕР II 30

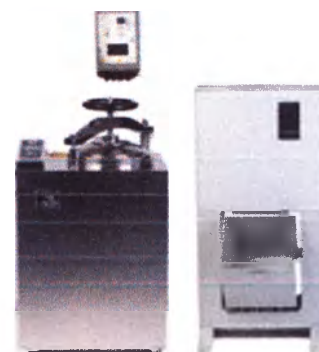


БАЛТНЕР II 50



БАЛТНЕР II 100

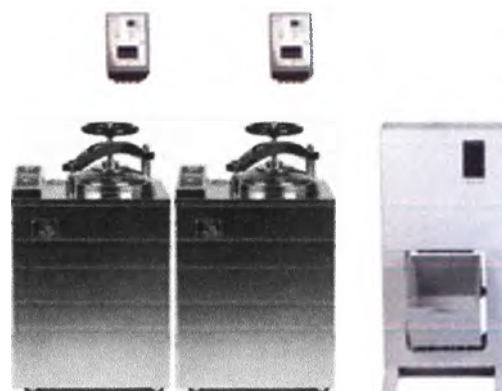


БАЛТНЕР II 50 НЕКСТ

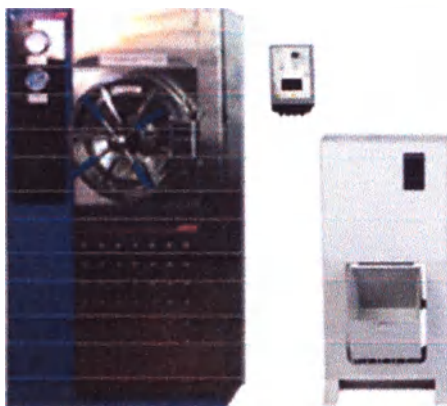

БАЛТНЕР II 75 НЕКСТ



БАЛТНЕР II 100 НЕКСТ

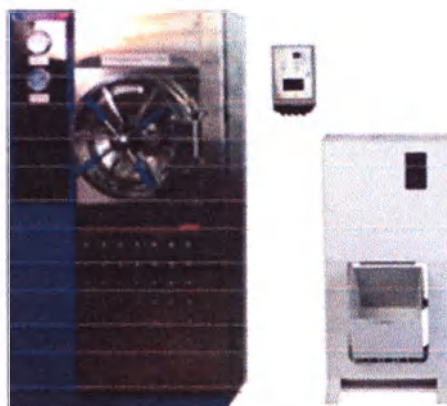

продукта, пропущенного
и скреплено печатью:

2 (два) листов

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.

Генеральный директор ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Крупницкий Д.Е.

