

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Д.Е. Крупицкий



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Установка для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР II-Ш» по ТУ 9452-005-61014306-2015»**

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-15)
с несъемным соединительным кабелем

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш15»

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (одуль 1-30)
с несъемным соединительным кабелем


Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш30»

ПРИЕМО-СДА
И ТЕХ. С

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-50)
с несъемным соединительным кабелем

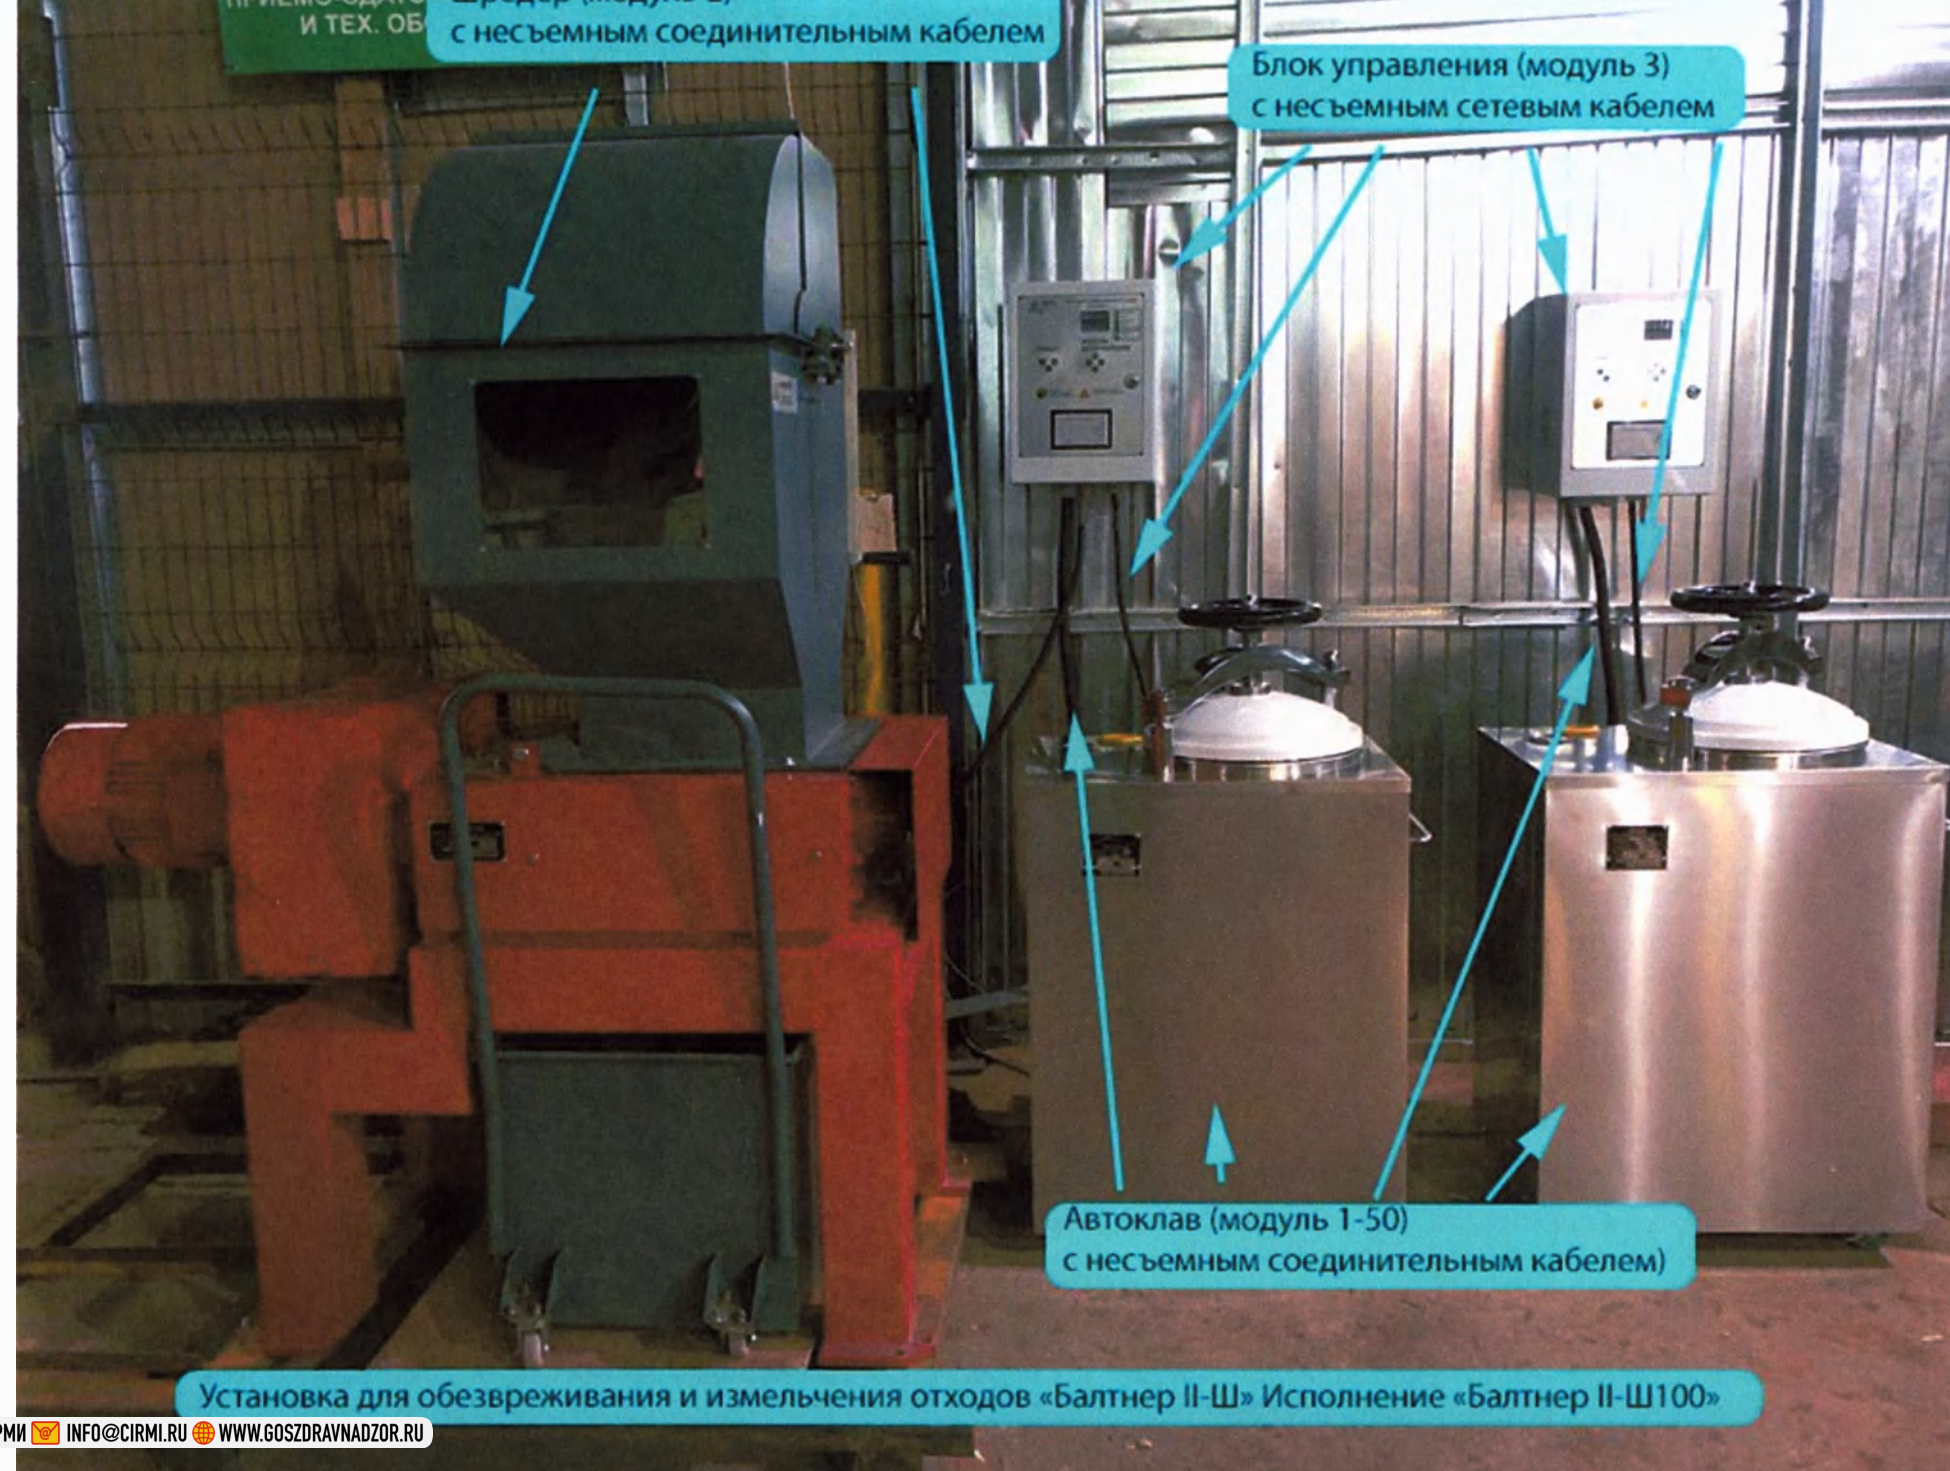


с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-50)
с несъемным соединительным кабелем)

Установка для обезвреживания и измельчения отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш100»

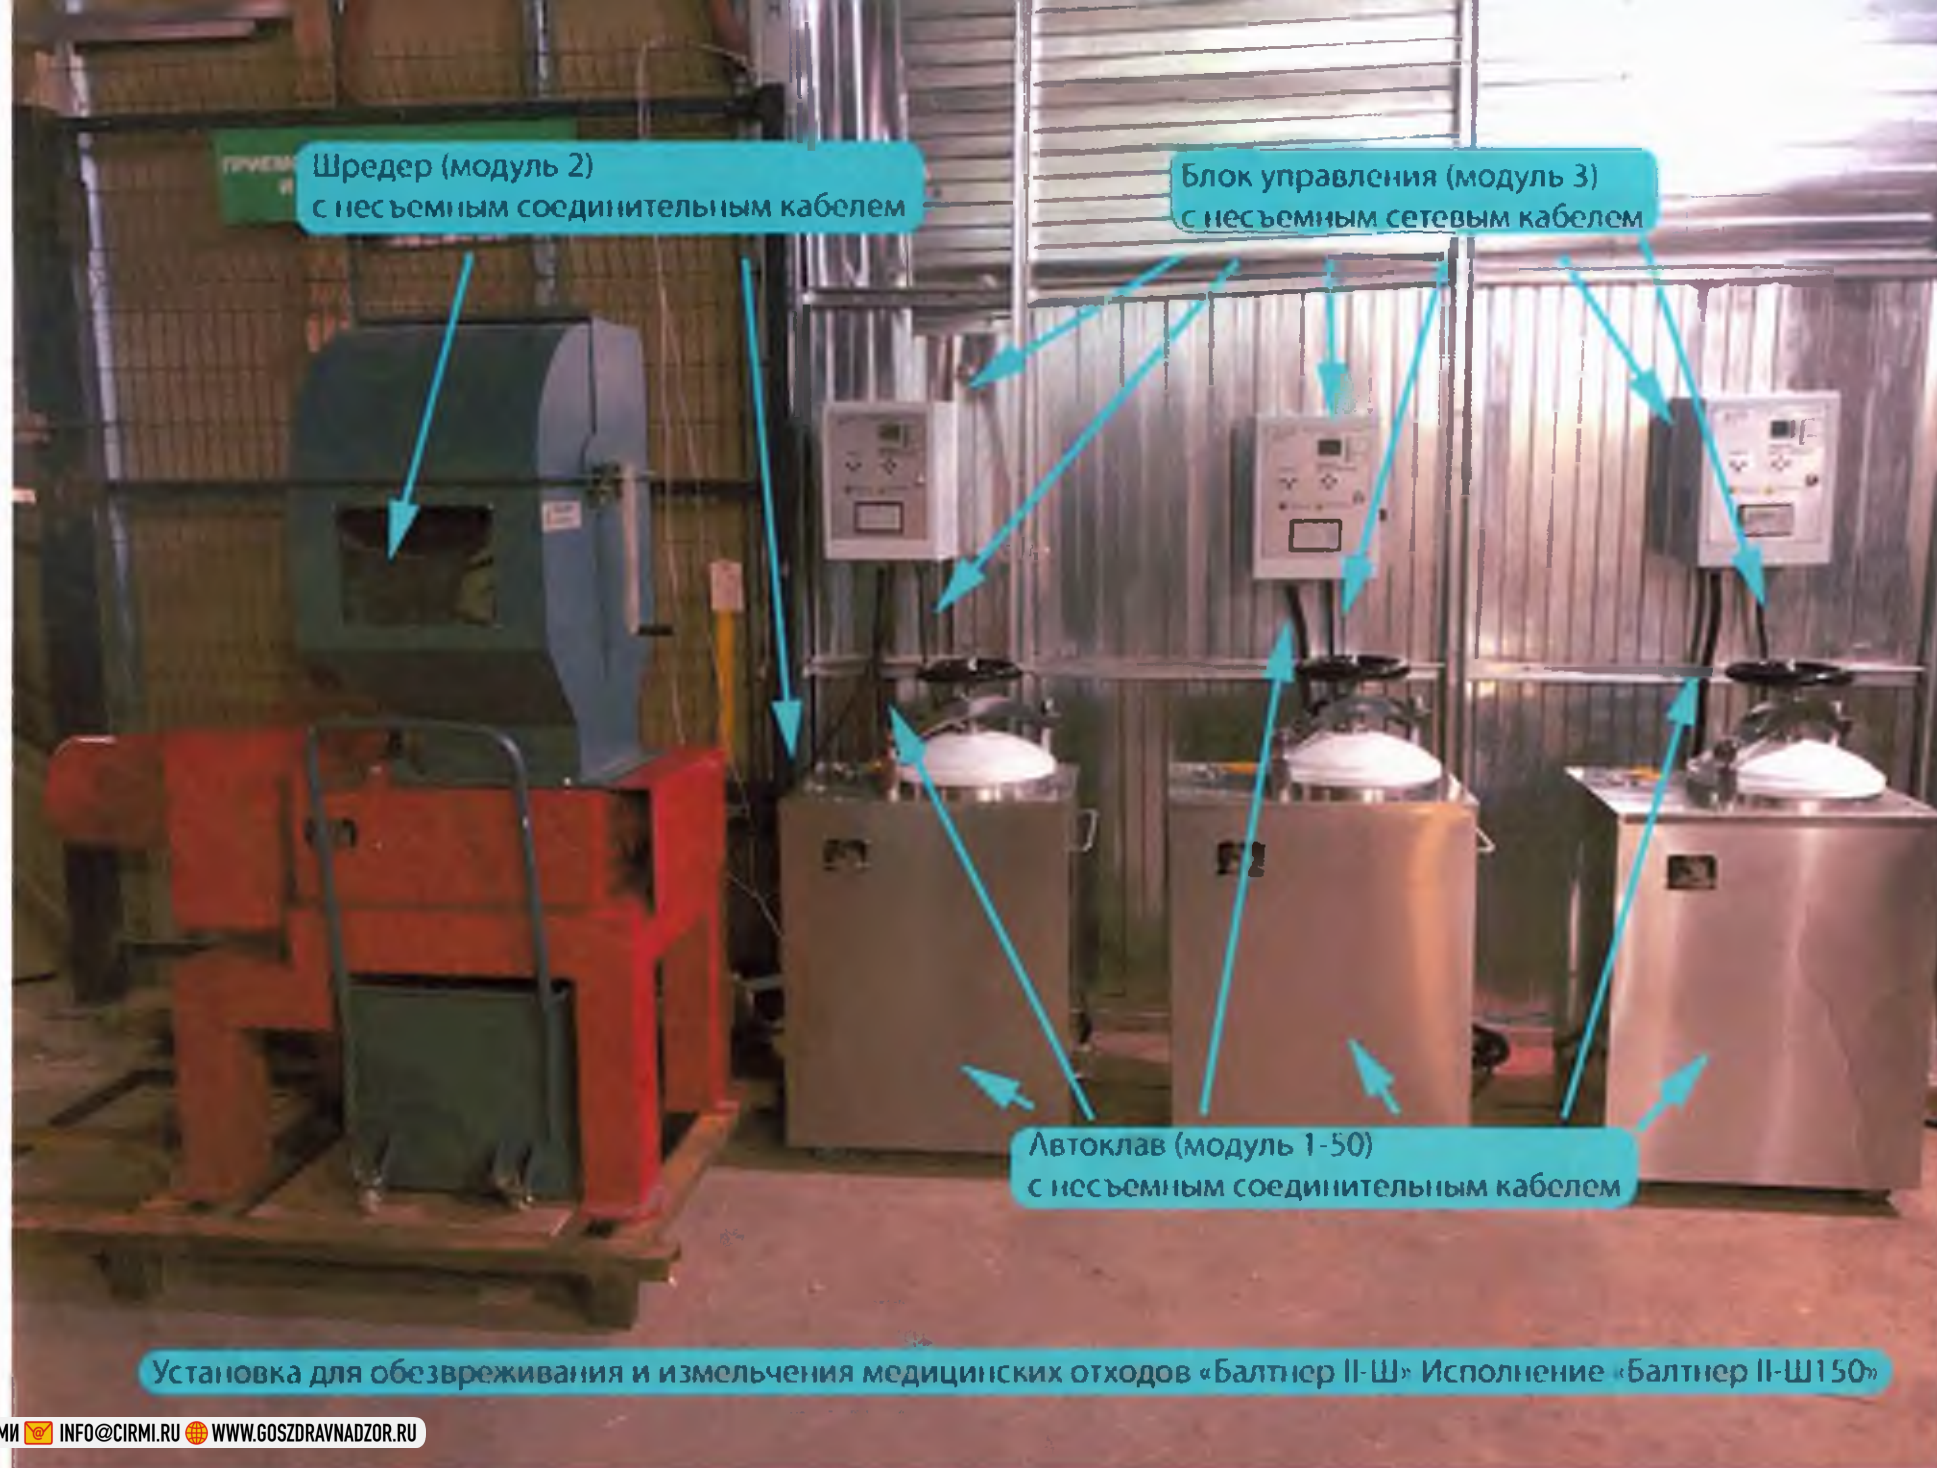


Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-50)
с несъемным соединительным кабелем

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш150»

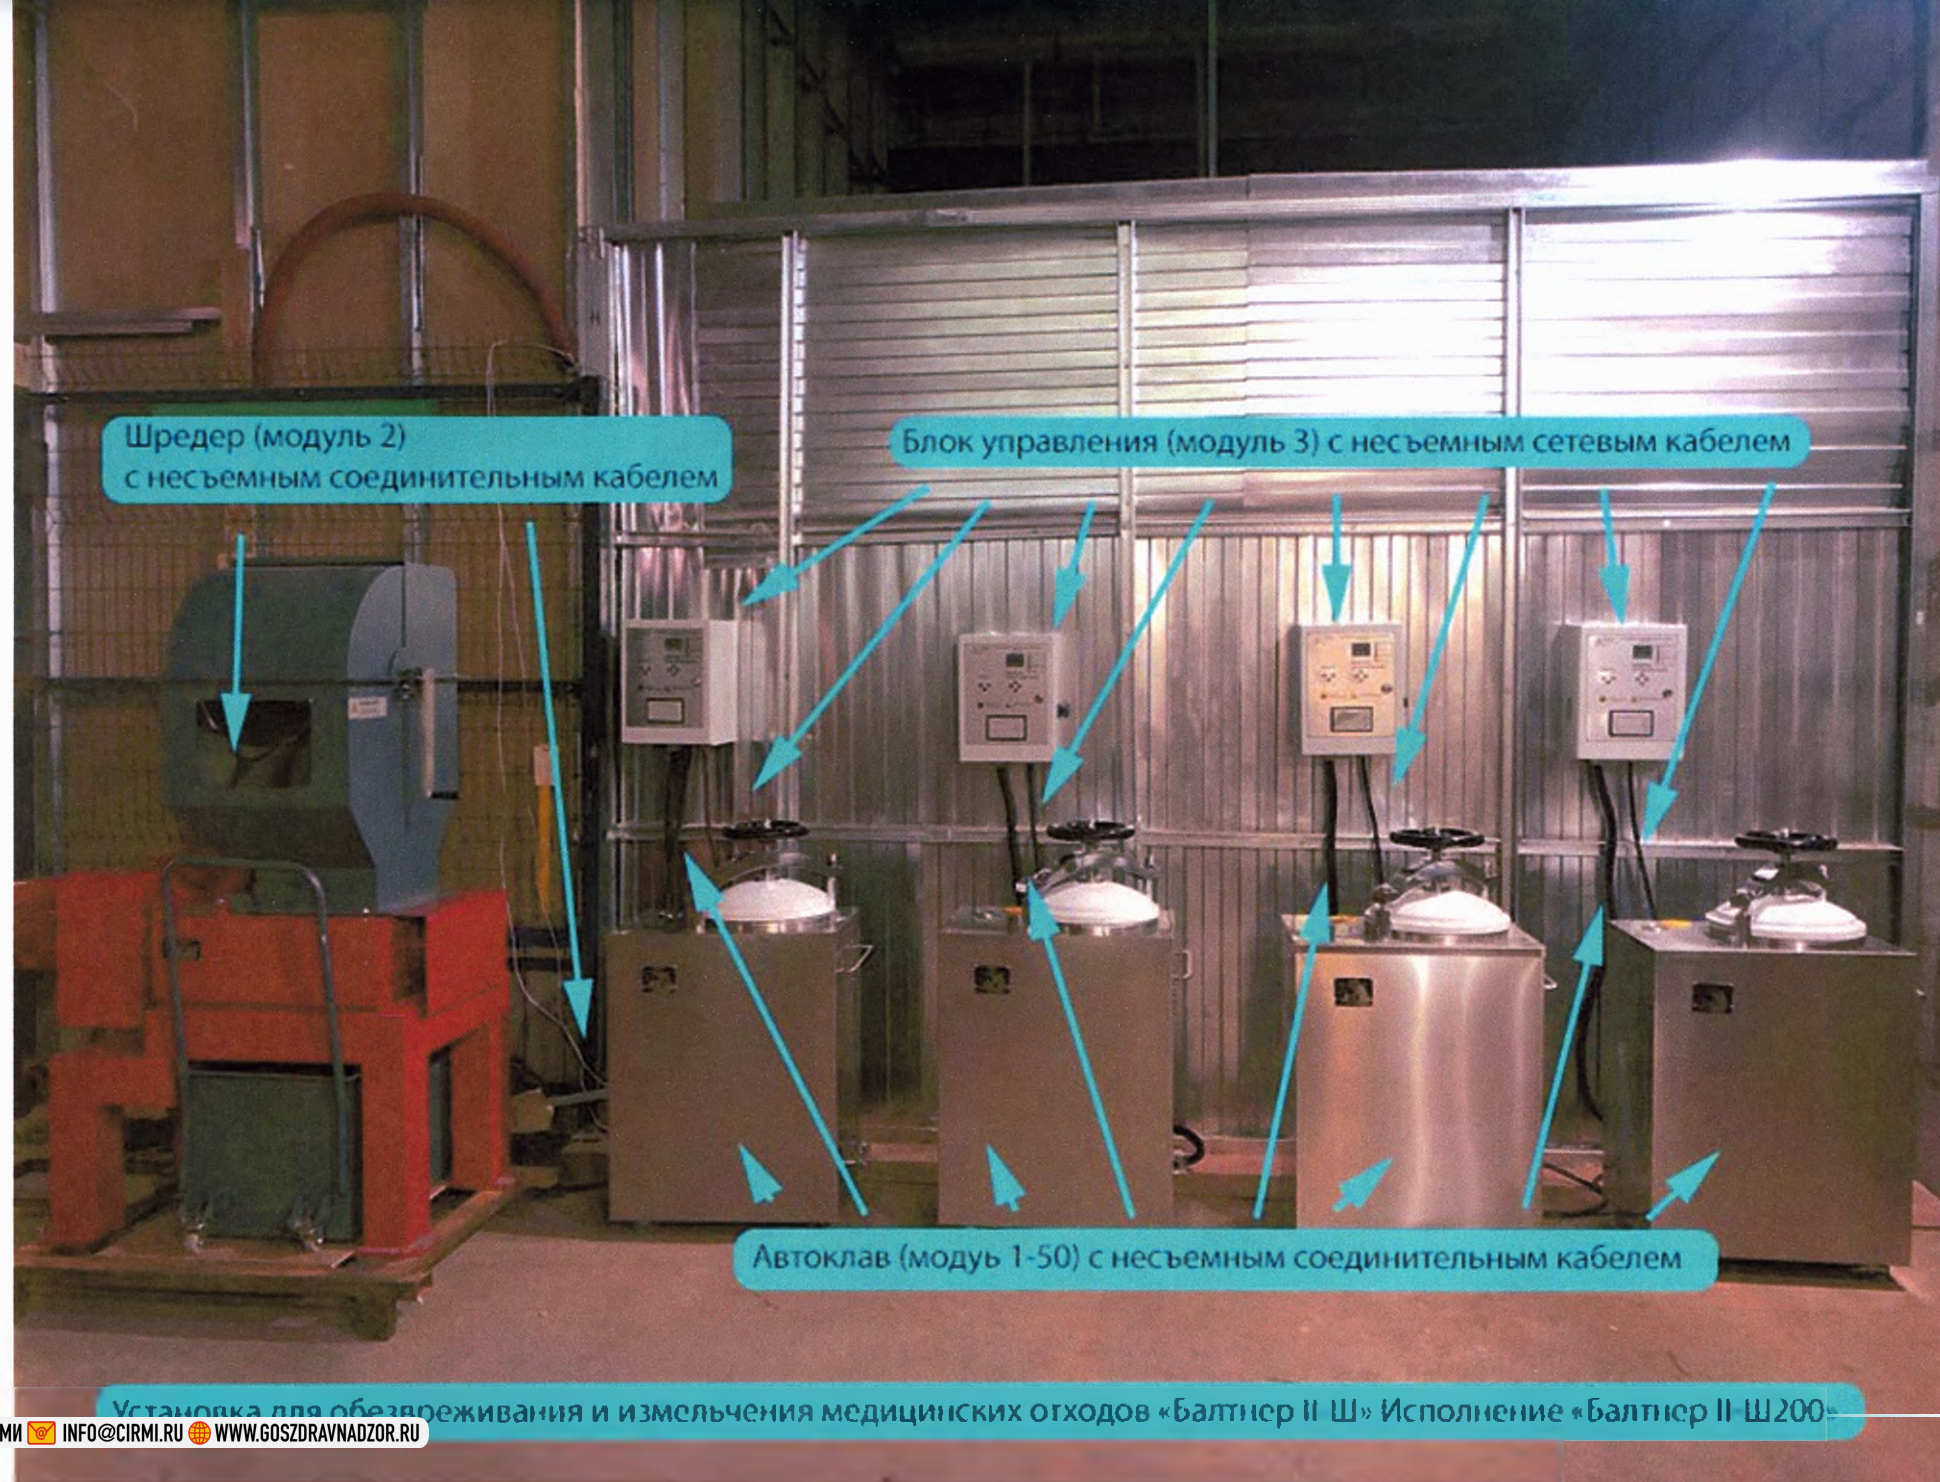

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3) с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-50) с несъемным соединительным кабелем


Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II Ш» Исполнение «Балтнер II Ш200»

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Автоклав (модуль 1-50 некст)
с несъемным соединительным кабелем

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение »Балтнер II-Ш 50 некст»

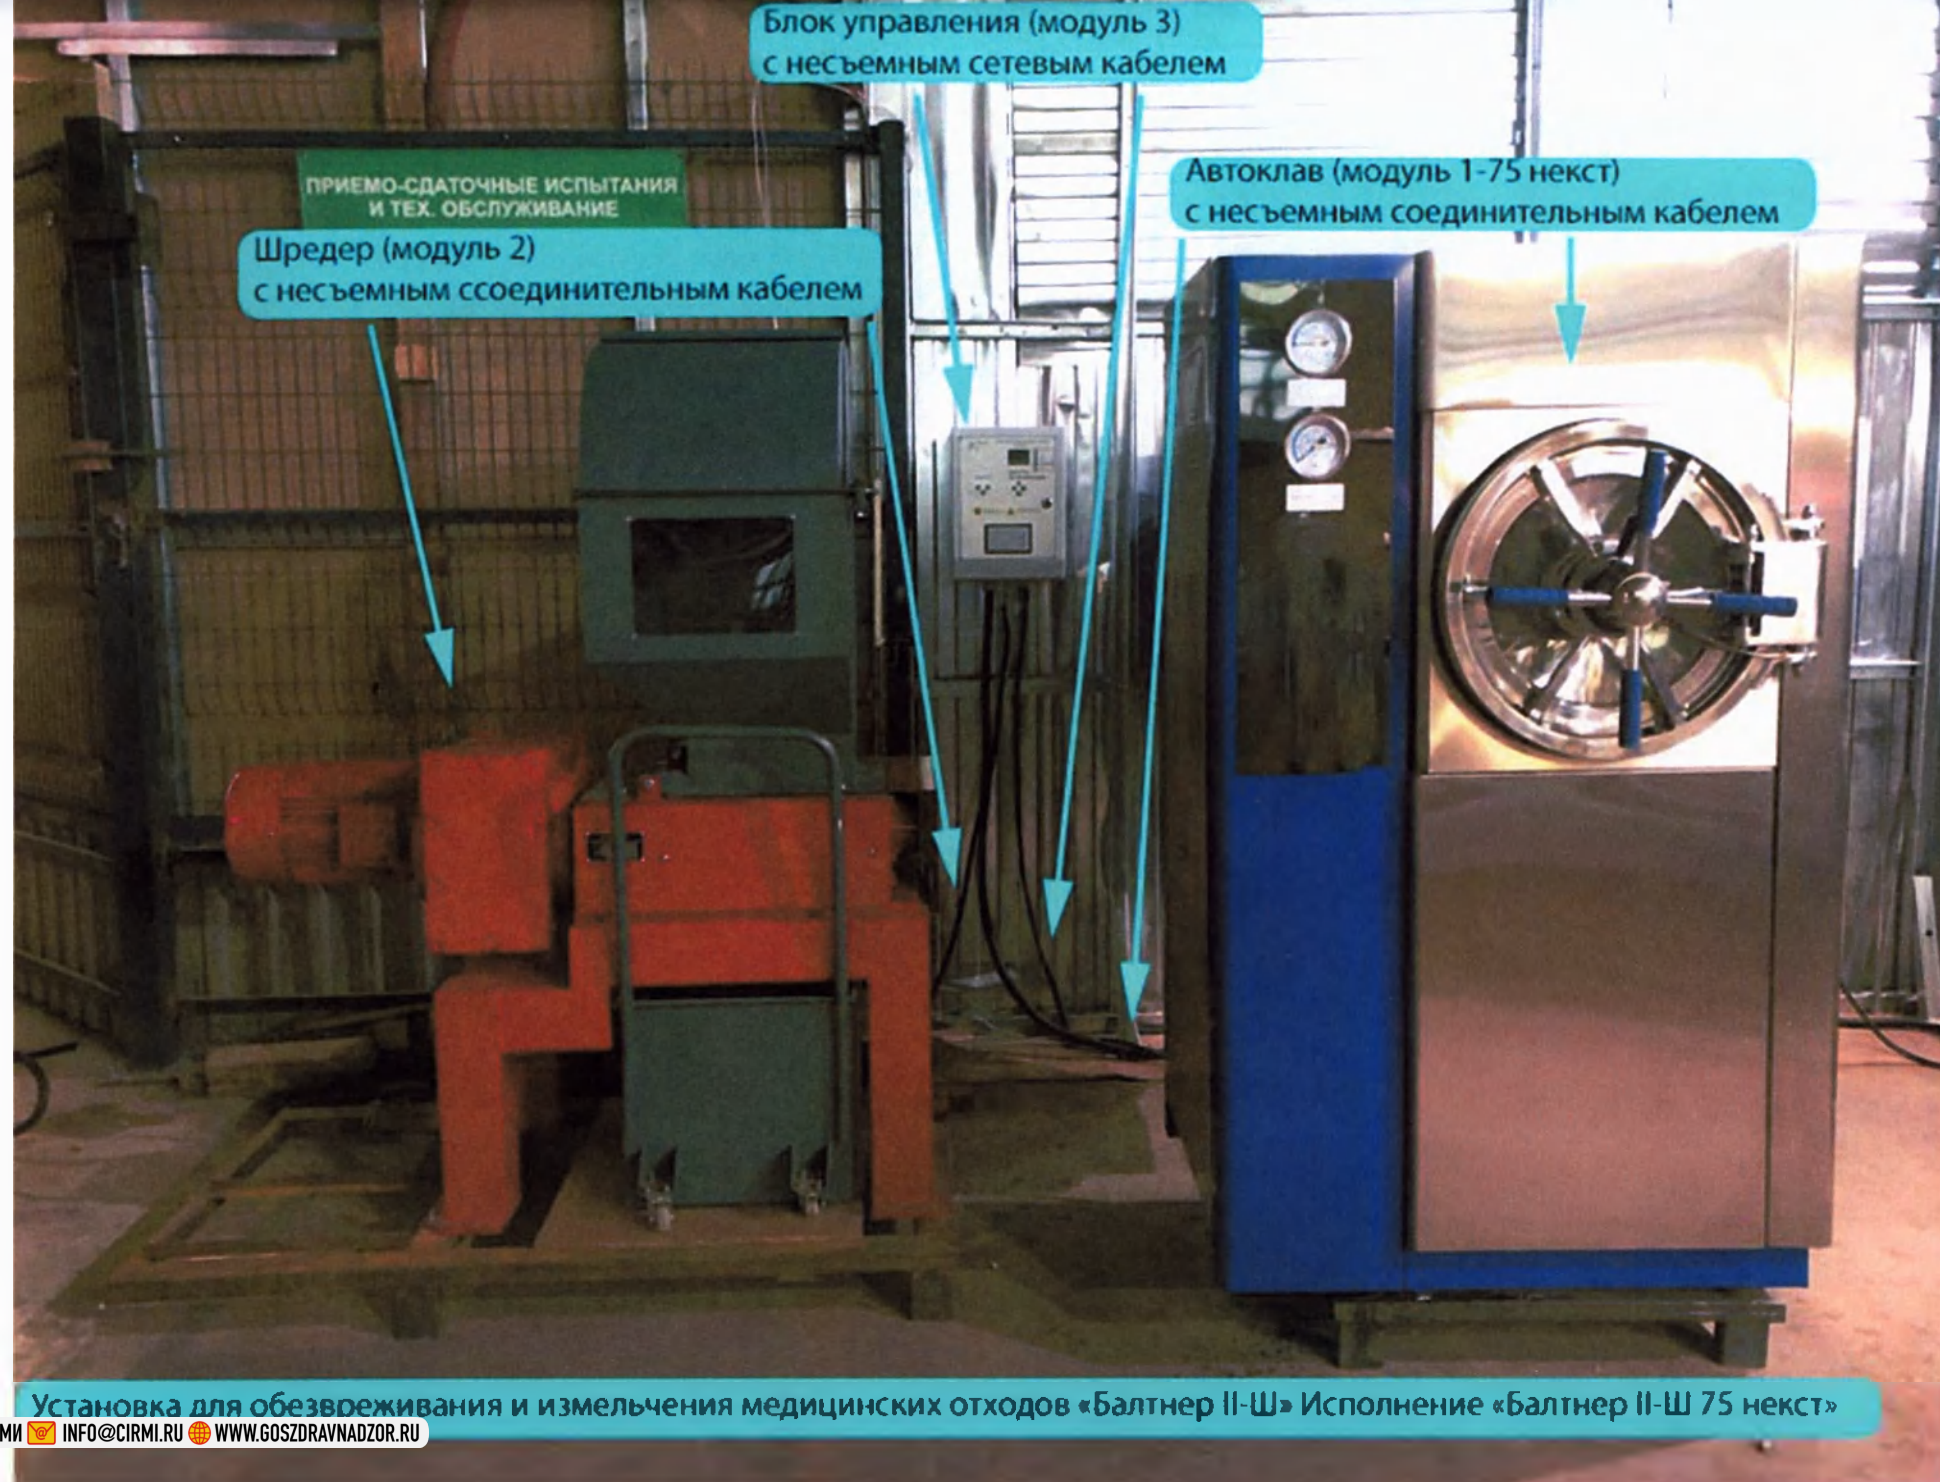


ПРИЕМО-ДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-75 некст)
с несъемным соединительным кабелем

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш 75 некст»

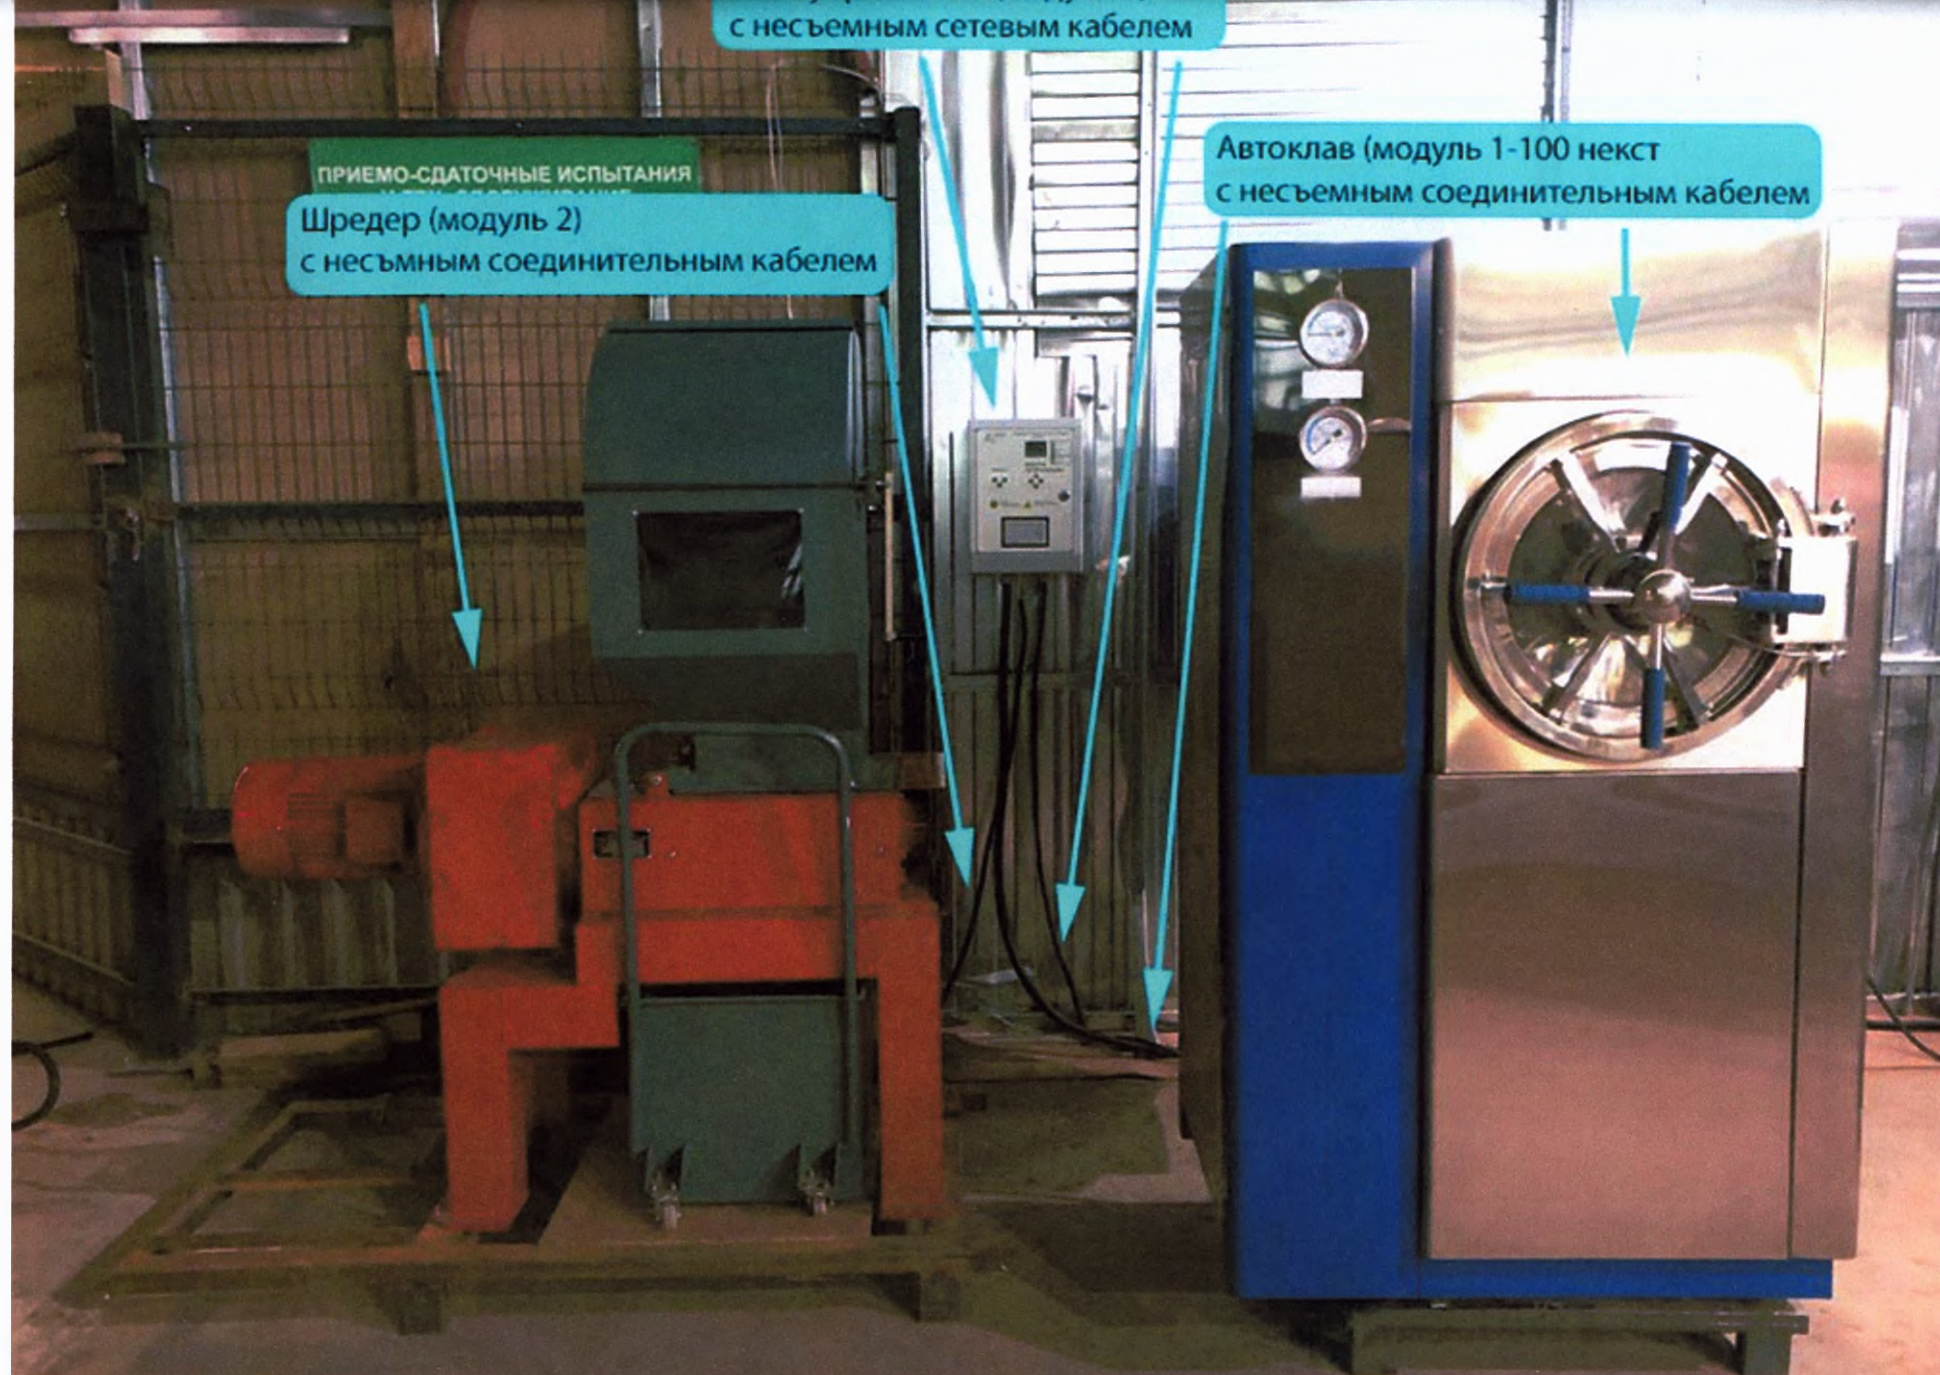

с несъемным сетевым кабелем

ПРИЕМО-ДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Автоклав (модуль 1-100 некст
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Автоклав (модуль 1-200 некст)
с несъемным соединительным кабелем

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Балтнер II-Ш» Исполнение «Балтнер II-Ш 200 некст»

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

ПРИЕМО-ДАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Автоклав (модуль 1-100 ПА)
с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Шредер (модуль 3)

с несъемным соединительным кабелем

Автоклав (модуль 1-200 ПА)

с несъемным соединительным кабелем

Блок управления (модуль 3)
с несъемным сетевым кабелем

Шредер (модуль 2)
с несъемным соединительным кабелем

Автоклав (модуль 1-280 ПА)
с несъемным соединительным кабелем

Промито:
Лол. во: 14
(четырнадцатая)
миссод

Ген. директор
Д. Е. Крутицкий

