

"УТВЕРЖДАЮ"


Генеральный директор ООО "ТестГен"

Тороповский А.Н.

"25" июня 2021 г.

М. П.

Копия верна  
генеральный директор ООО "ТестГен"  
Тороповский А.Н.

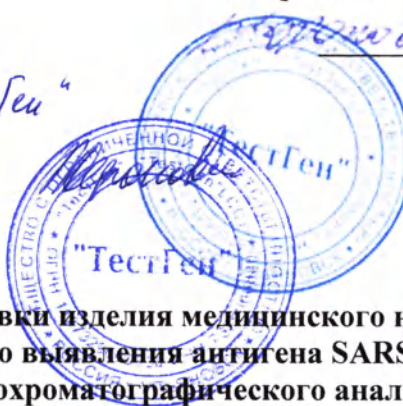

**Макет этикеток упаковки изделия медицинского назначения  
Набор реагентов для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в клиническом  
материале человека методом иммунохроматографического анализа «SARS-CoV-2 antigen  
test», партия 202102-31**

Макет этикеток компонентов набора реагентов

*Вариант исполнения 1 «SARS-CoV-2 antigen test», партия 202102-31*

|                |                                                |         |              |
|----------------|------------------------------------------------|---------|--------------|
|                | <b>Пробирка с буфером</b> 25 шт. по 250 мкл    |         |              |
|                | Вариант исполнения 1 «SARS-CoV-2 antigen test» |         |              |
| LOT            | 202102-31                                      | 2021-02 | +2 ... +30°C |
|                |                                                | 2023-02 | IVD          |
|                | <b>Зонд для забора биоматериала</b> 25 шт.     |         |              |
|                | Вариант исполнения 1 «SARS-CoV-2 antigen test» |         |              |
| LOT            | 202102-31                                      | 2021-02 | +2 ... +30°C |
| STERILE EO (2) |                                                | 2023-02 | IVD          |
|                | <b>Тестовая кассета</b>                        |         |              |
|                | Вариант исполнения 1 «SARS-CoV-2 antigen test» |         |              |
| LOT            | 202102-31                                      | 2021-02 | +2 ... +30°C |
|                |                                                | 2023-02 | IVD          |

*Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test», партия 202102-31*

|                |                                                         |         |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                | <b>Буфер для пробоподготовки</b> 6 мл                   |         |              |
|                | Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test»          |         |              |
| LOT            | 202102-31                                               | 2021-02 | +2 ... +30°C |
|                |                                                         | 2023-02 | IVD          |
|                | <b>Пробирка пустая с насадкой-капельницей</b> по 25 шт. |         |              |
|                | Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test»          |         |              |
| LOT            | 202102-31                                               | 2021-02 | +2 ... +30°C |
|                |                                                         | 2023-02 | IVD          |
|                | <b>Зонд для забора биоматериала</b> 25 шт.              |         |              |
|                | Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test»          |         |              |
| LOT            | 202102-31                                               | 2021-02 | +2 ... +30°C |
| STERILE EO (2) |                                                         | 2023-02 | IVD          |
|                | <b>Тестовая кассета</b>                                 |         |              |
|                | Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test»          |         |              |
| LOT            | 202102-31                                               | 2021-02 | +2 ... +30°C |
|                |                                                         | 2023-02 | IVD          |

**Макет этикетки на коробку**  
**Набор реагентов «SARS-CoV-2 antigen test», партия 202102-31, вариант исполнения 1**

**Набор реагентов для качественного выявления антигена  
SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом  
иммунохроматографического анализа  
«SARS CoV-2 antigen test», партия 202102-31  
Вариант исполнения 1**

**Состав набора:**

|                                                                                   |              |                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
|  | 202102-31    | Тестовая кассета                          | 25 шт.            |
|  | 2021-02      | Пробирка для<br>пробоподготовки с буфером | 25 шт. по 250 мкл |
|  | 2023-02      | Зонд для забора                           | 25 шт.            |
|  | 25           | биоматериала                              |                   |
|  | От 2 до 30°C |                                           |                   |
|  | ру ____/____ |                                           |                   |
| Только для <i>in vitro</i> диагностики                                            |              |                                           |                   |
| Только для профессионального применения                                           |              |                                           |                   |



ООО «ТестГен»  
432072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13  
Тел.: +7(493)705-03-75  
info@testgen.ru

**Набор реагентов «SARS-CoV-2 antigen test», партия 202102-31, вариант исполнения 2**

**Набор реагентов для качественного выявления антигена  
SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом  
иммунохроматографического анализа  
«SARS CoV-2 antigen test», партия 202102-31  
Вариант исполнения 2**


**Состав набора:**

|                                                                                     |              |                                        |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|--|
|  | 202102-31    | Тестовая кассета                       | 25 шт.            |  |
|  | 2021-02      | Пробирка пустая с насадкой-капельницей | по 25 шт.         |  |
|  | 2023-02      | Буфер для пробоподготовки              | 2 флакона по 6 мл |  |
|  | 25           | Зонд для забора биоматериала           |                   |  |
|  | От 2 до 30°C |                                        |                   |  |
|  | ру ____/____ |                                        |                   |  |



Только для *in vitro* диагностики  
Только для профессионального применения

ООО «ТестГен»  
432072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13  
Тел.: +7(493)705-03-75  
info@testgen.ru

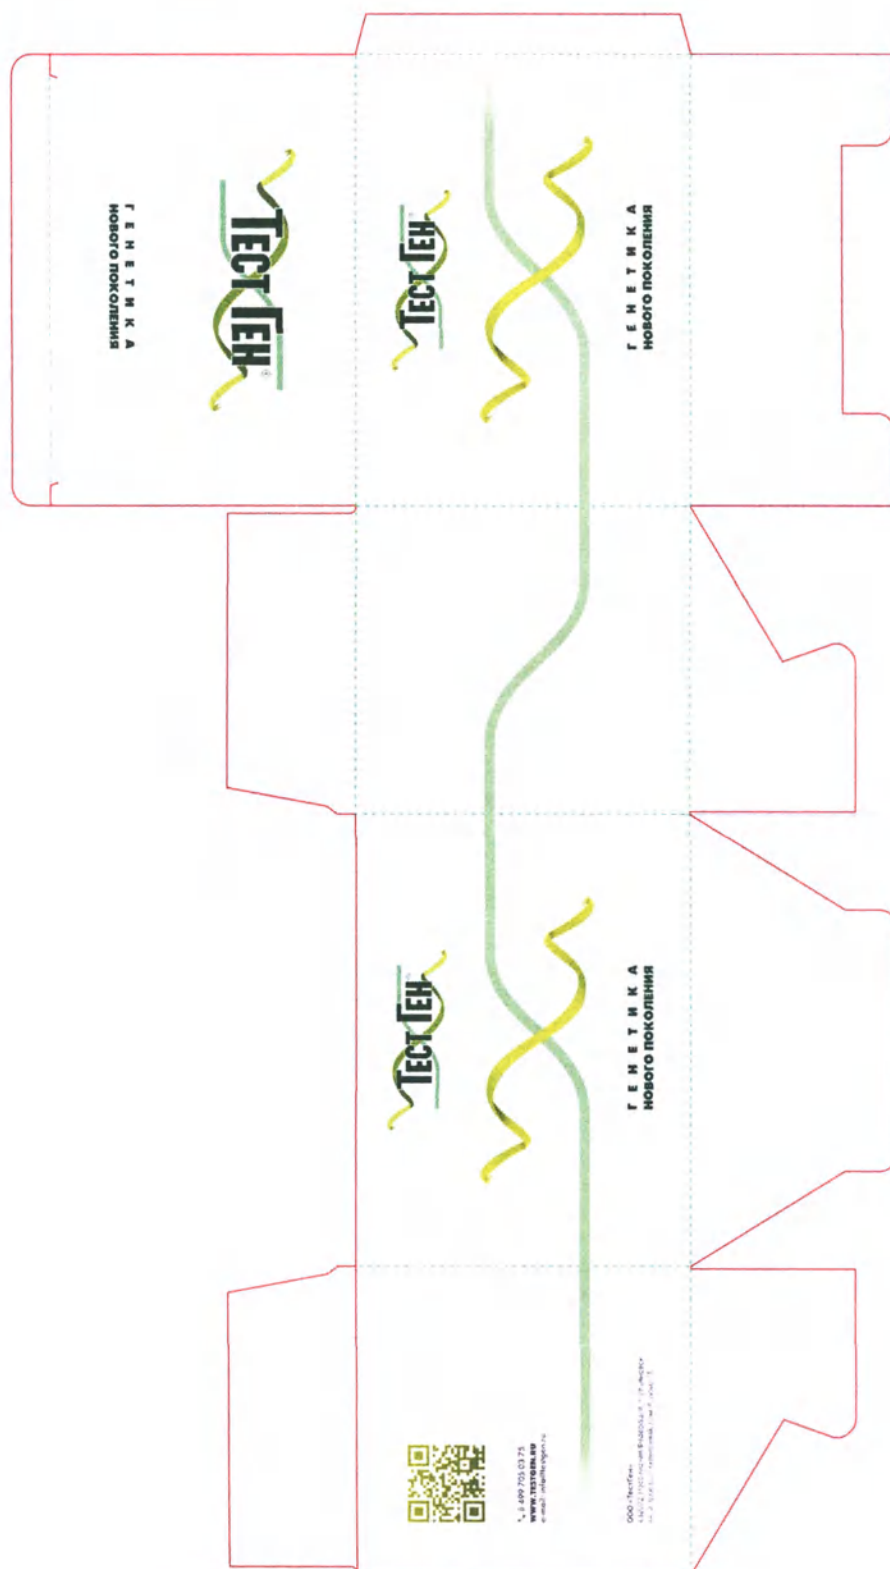

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

3 ( три ) листов

Должность: ген. директор  
Тороповский А.Н.



Набор реактивов для качественного выявления антител к SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом иммунохроматографического анализа «SARS CoV-2 antigen test», партия 202102-31

Вариант исполнения 1

**Состав набора:**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Тестовая кассета                       | 25 шт.            |
| Пробирки для пробоподготовки с буфером | 25 шт. по 250 мкл |
| Зонды для забора биоматериала          | 25 шт.            |

От 2 до 30°C

202102-31

2021-02

2023-02

25



ООО «Тестген»  
432022 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный корпус, пом. 5, офис 18  
Тел.: +7(499)709-03-78  
info@testgen.ru


Только для in vitro диагностики  
Только для профессионального применения

RU







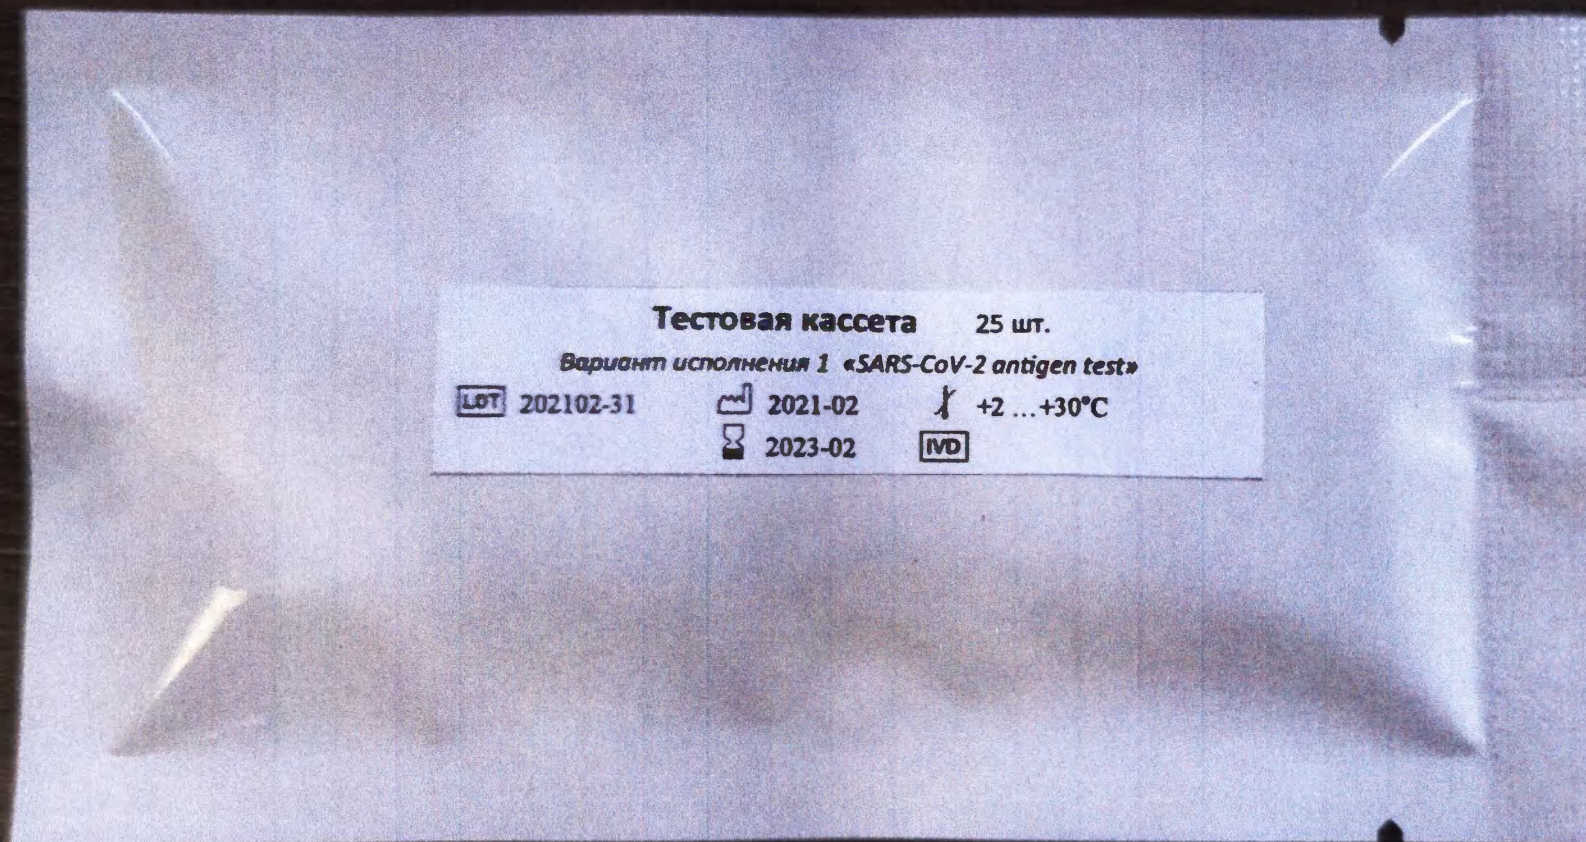

**Набор реагентов для качественного выявления антигена  
SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом  
иммунохроматографического анализа  
«SARS CoV-2 antigen test», партия 202102-31  
Вариант исполнения 2**

**Состав набора:**

|                                                                                     |              |                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|
|  | 202102-31    | Тестовая кассета                       | 25 шт.            |
|  | 2021-02      | Пробирка пустая с насадкой-капельницей | по 25 шт.         |
|  | 2023-02      | Буфер для пробоподготовки              | 2 флакона по 6 мл |
|  | 25           | Зонд для забора биоматериала           | 25 шт.            |
|  | От 2 до 30°C |                                        |                   |


RU    /   

Только для *in vitro* диагностики

Только для профессионального применения




ООО «ТестГен»  
432072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, дом 9, офис 13  
Тел.: +7(432)705-83-75  
info@testgen.ru

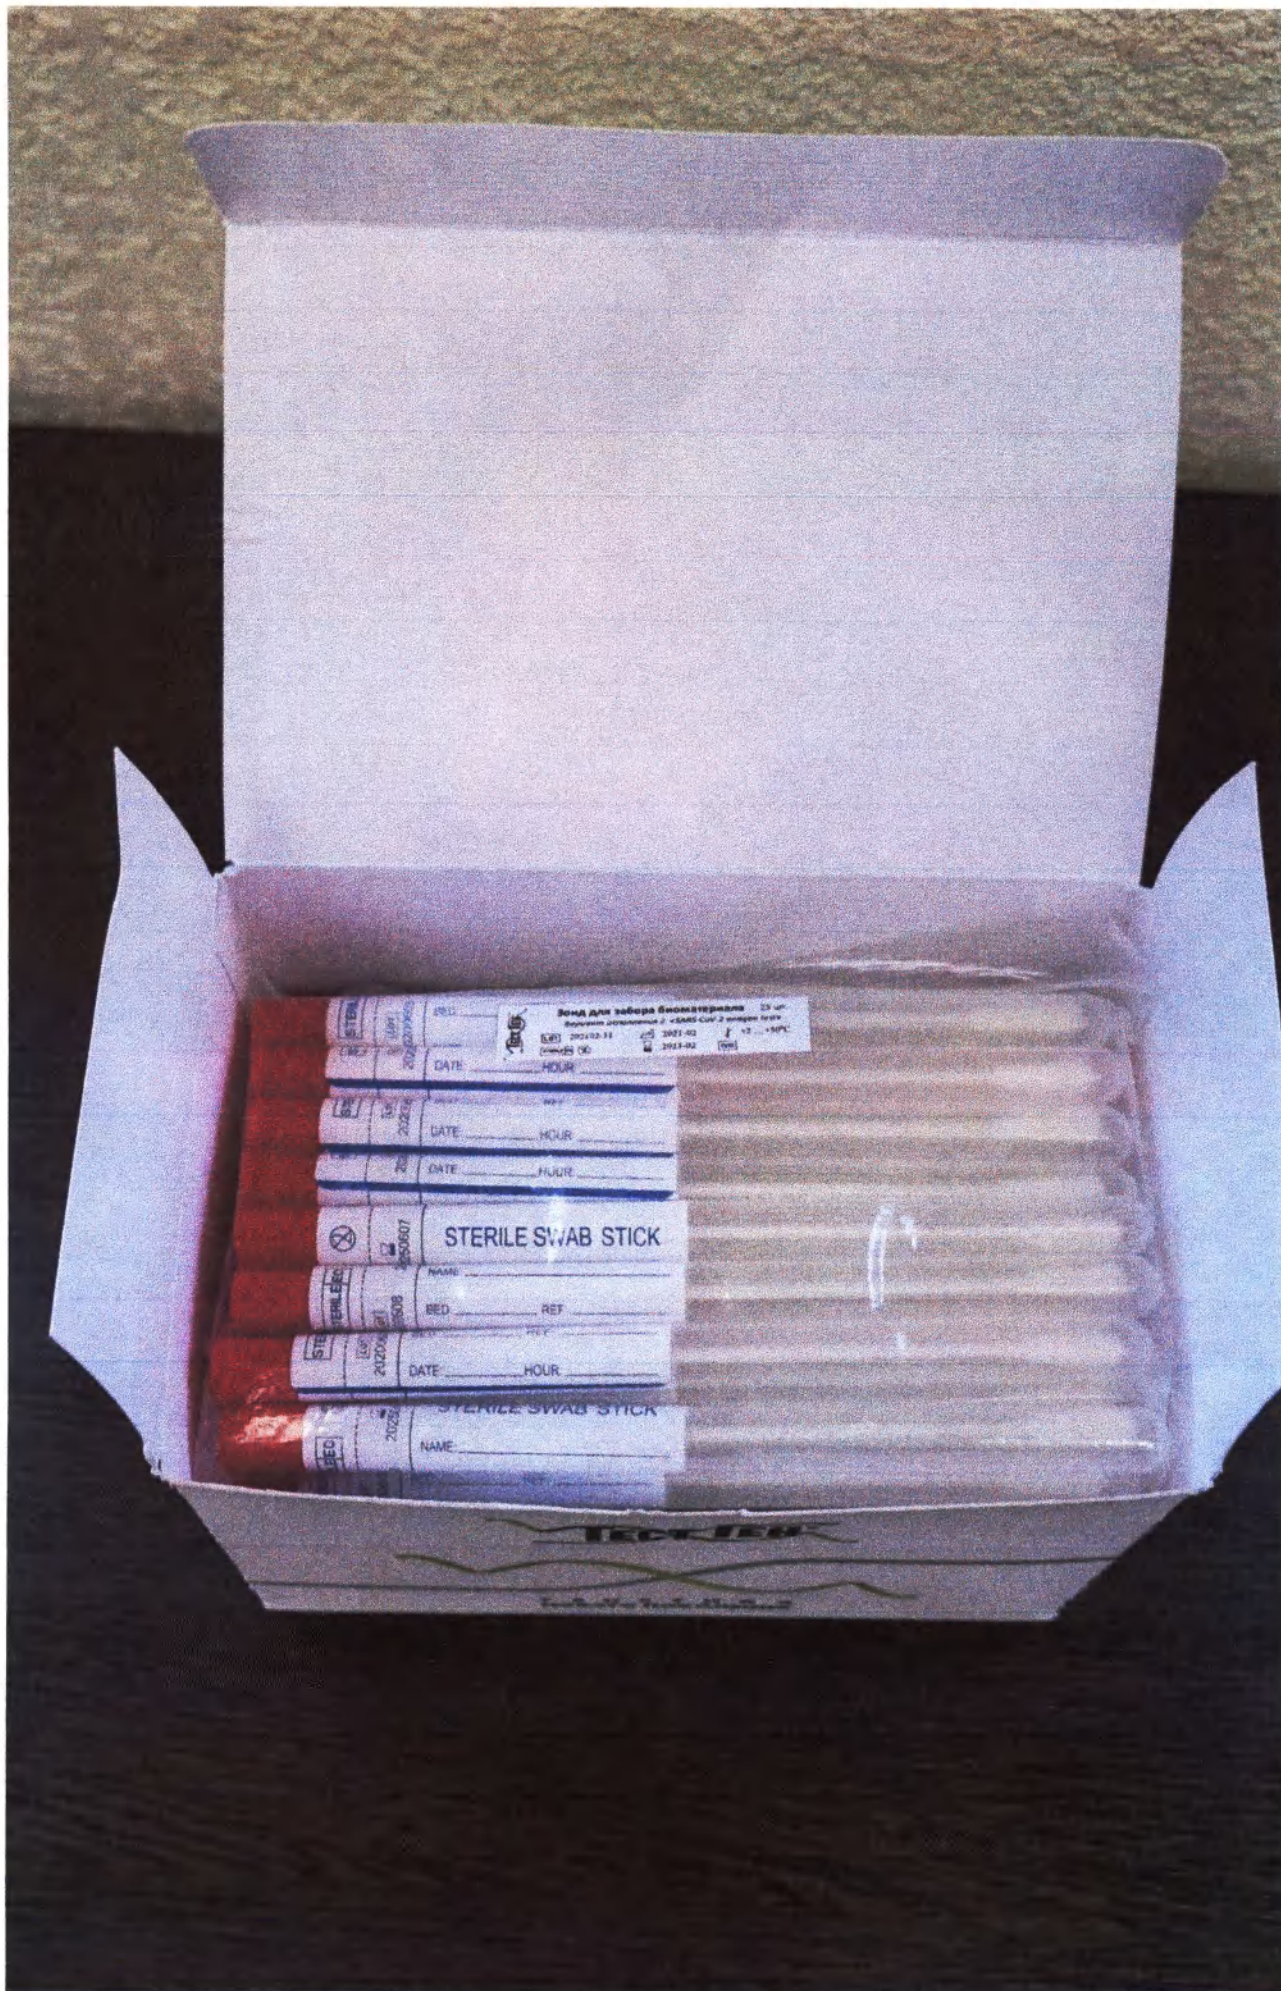



**Тестовая кассета 25 шт.**  
**Вариант исполнения 2 «SARS-CoV-2 antigen test»**  
**LOT** 202102-31     2021-02     +2 ...+30°C  
 2023-02    **IVD**

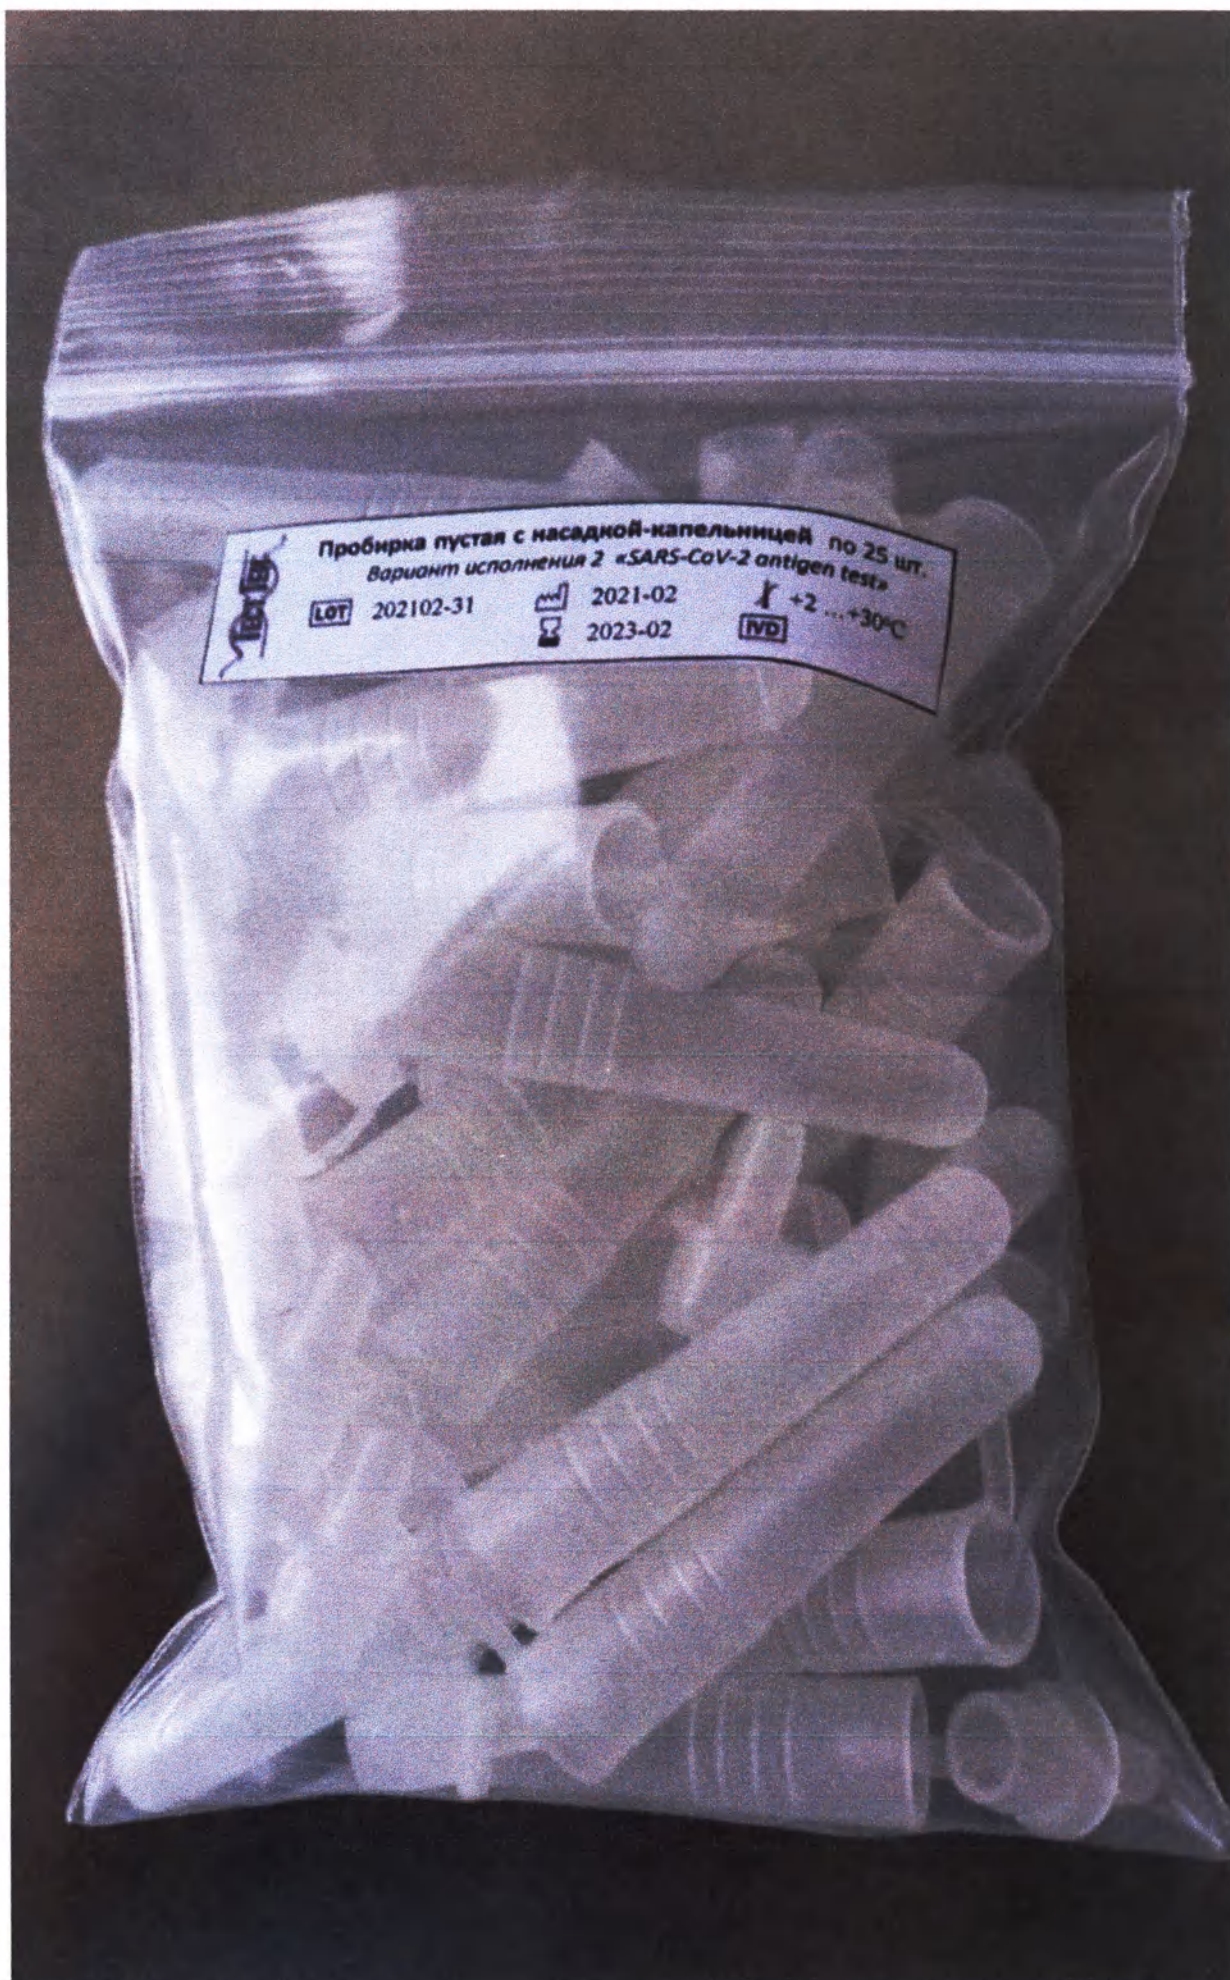

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность: ген. директор

Тороповский А.Н.

