



HARIKO DENTA MED

Your partner for health care products & service

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Харико Дента Мед"


И.Д. Бадгали

июль 2021 г.




Фотографии изделия медицинского назначения


Аппарат цифровой 3D-панорамный дентальный рентгеновский VistaVox S

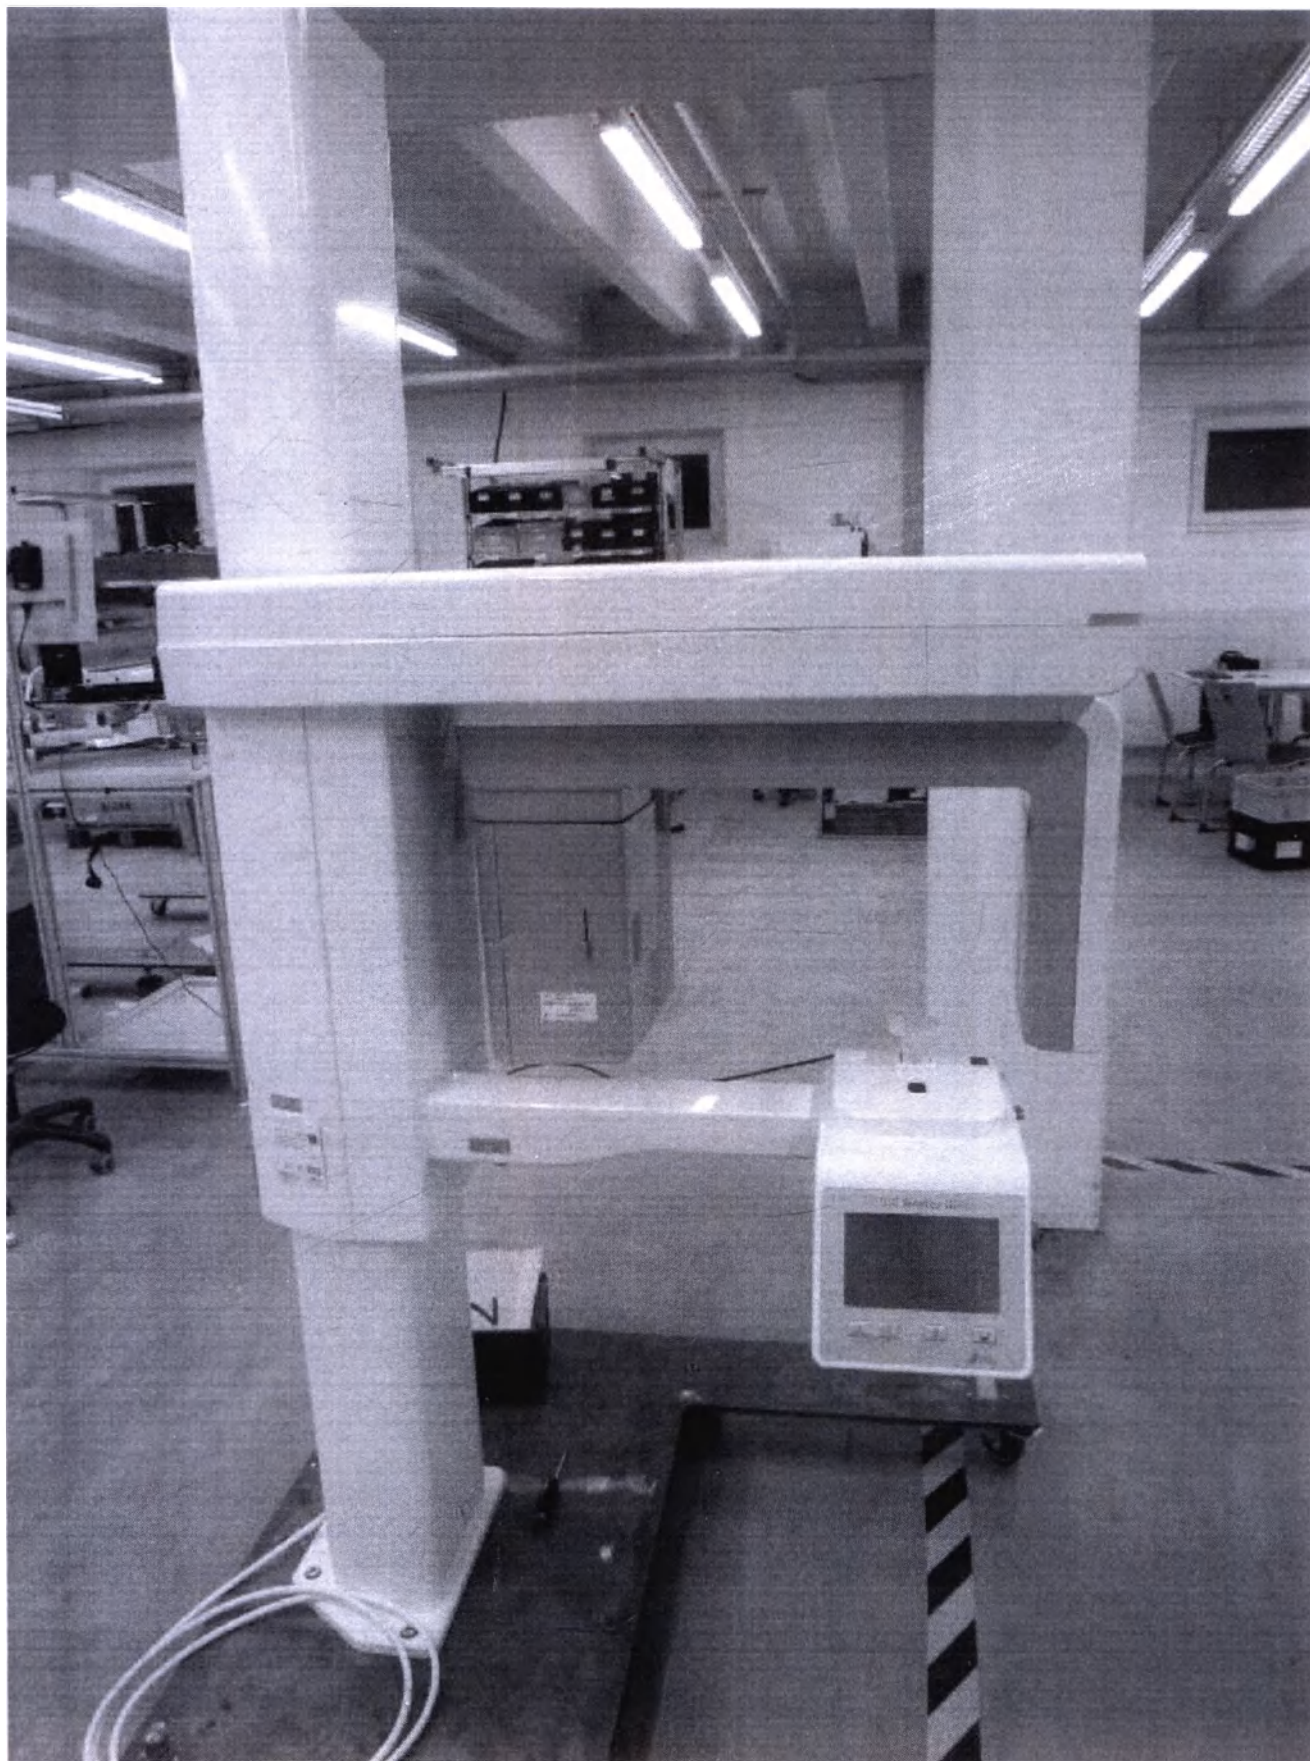


Аппарат цифровой 3D-панорамный дентальный рентгеновский VistaVox S

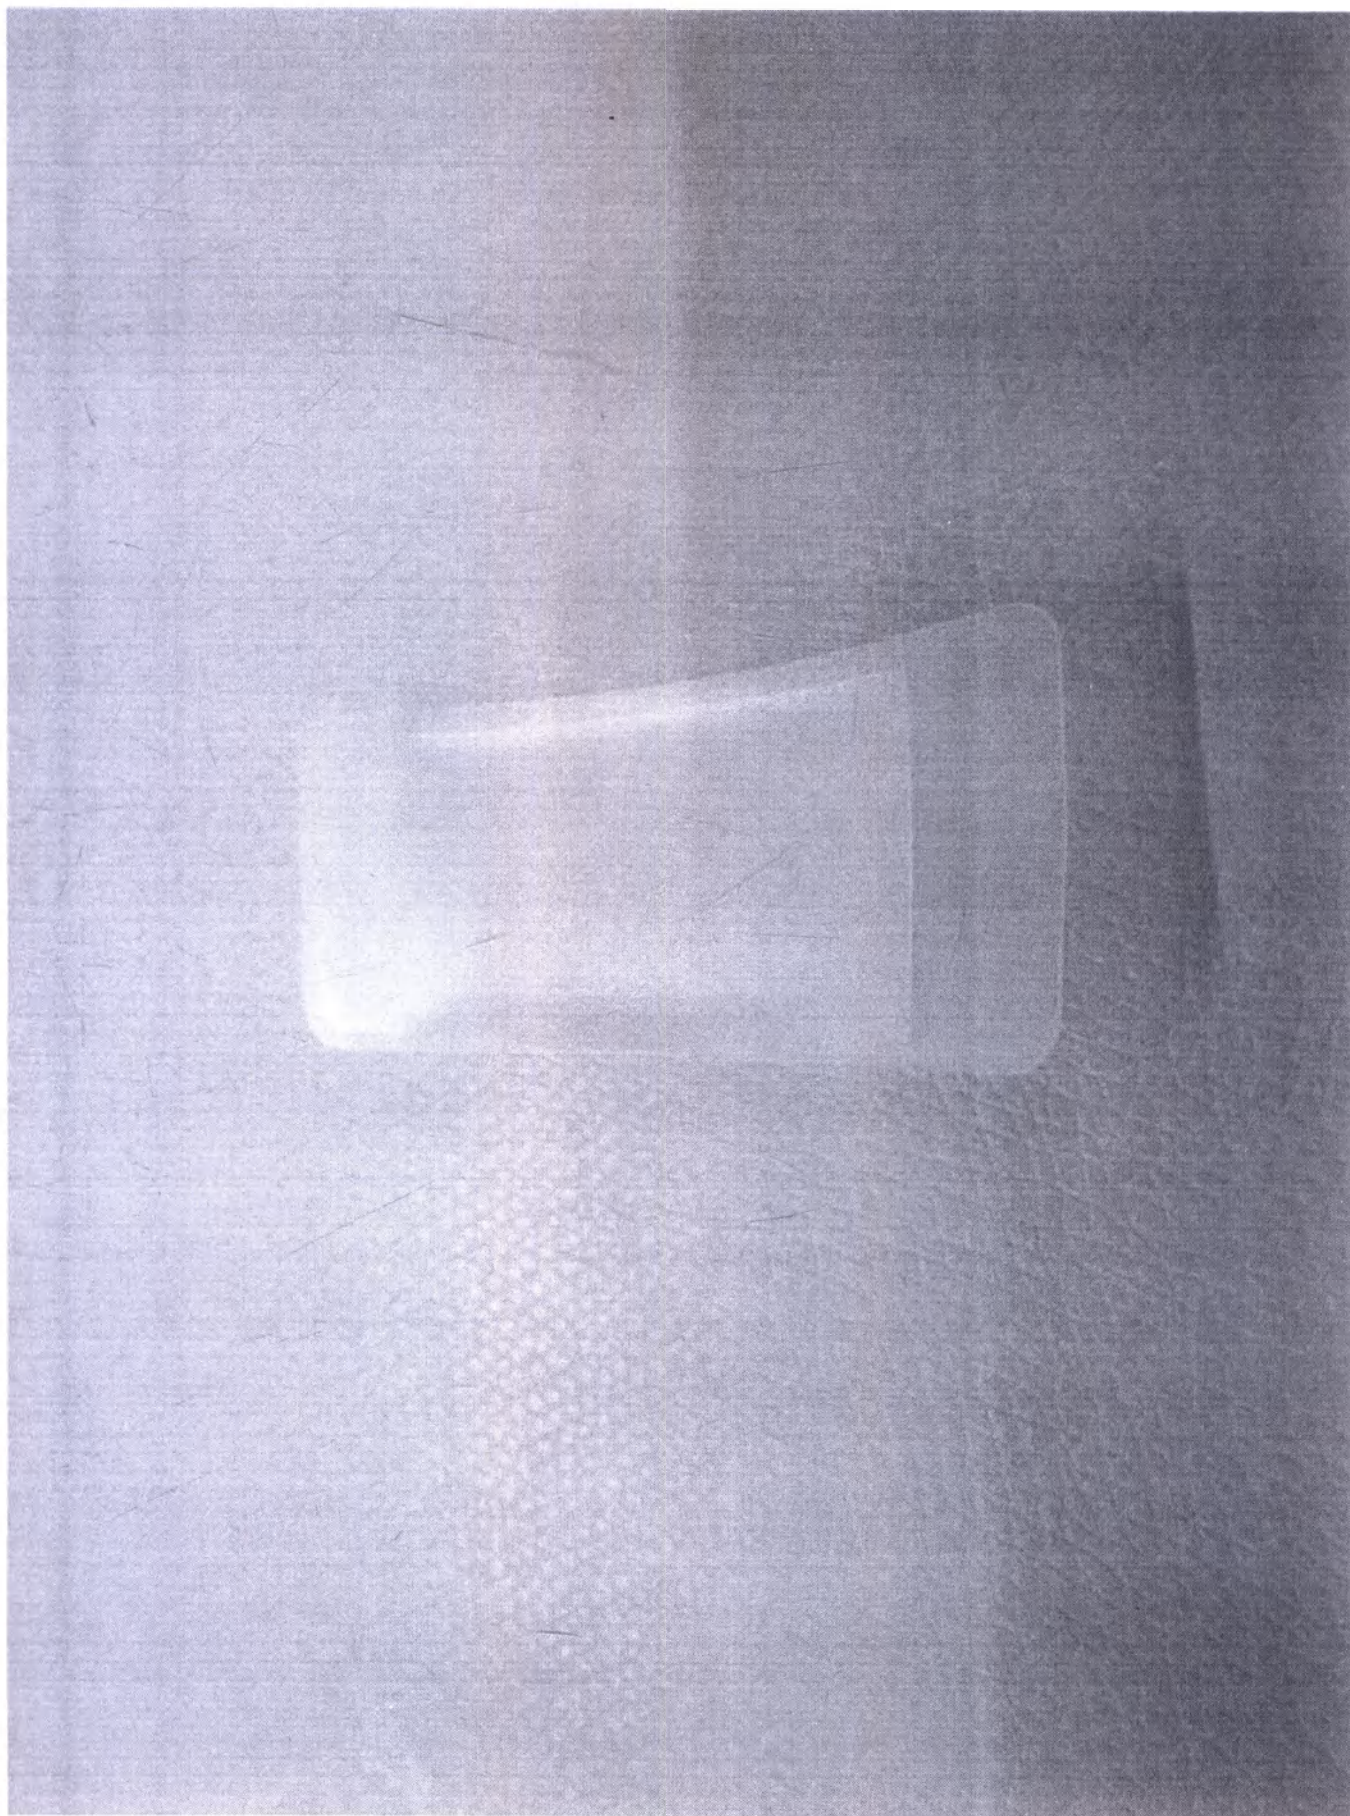


Чехол для прикусного блока

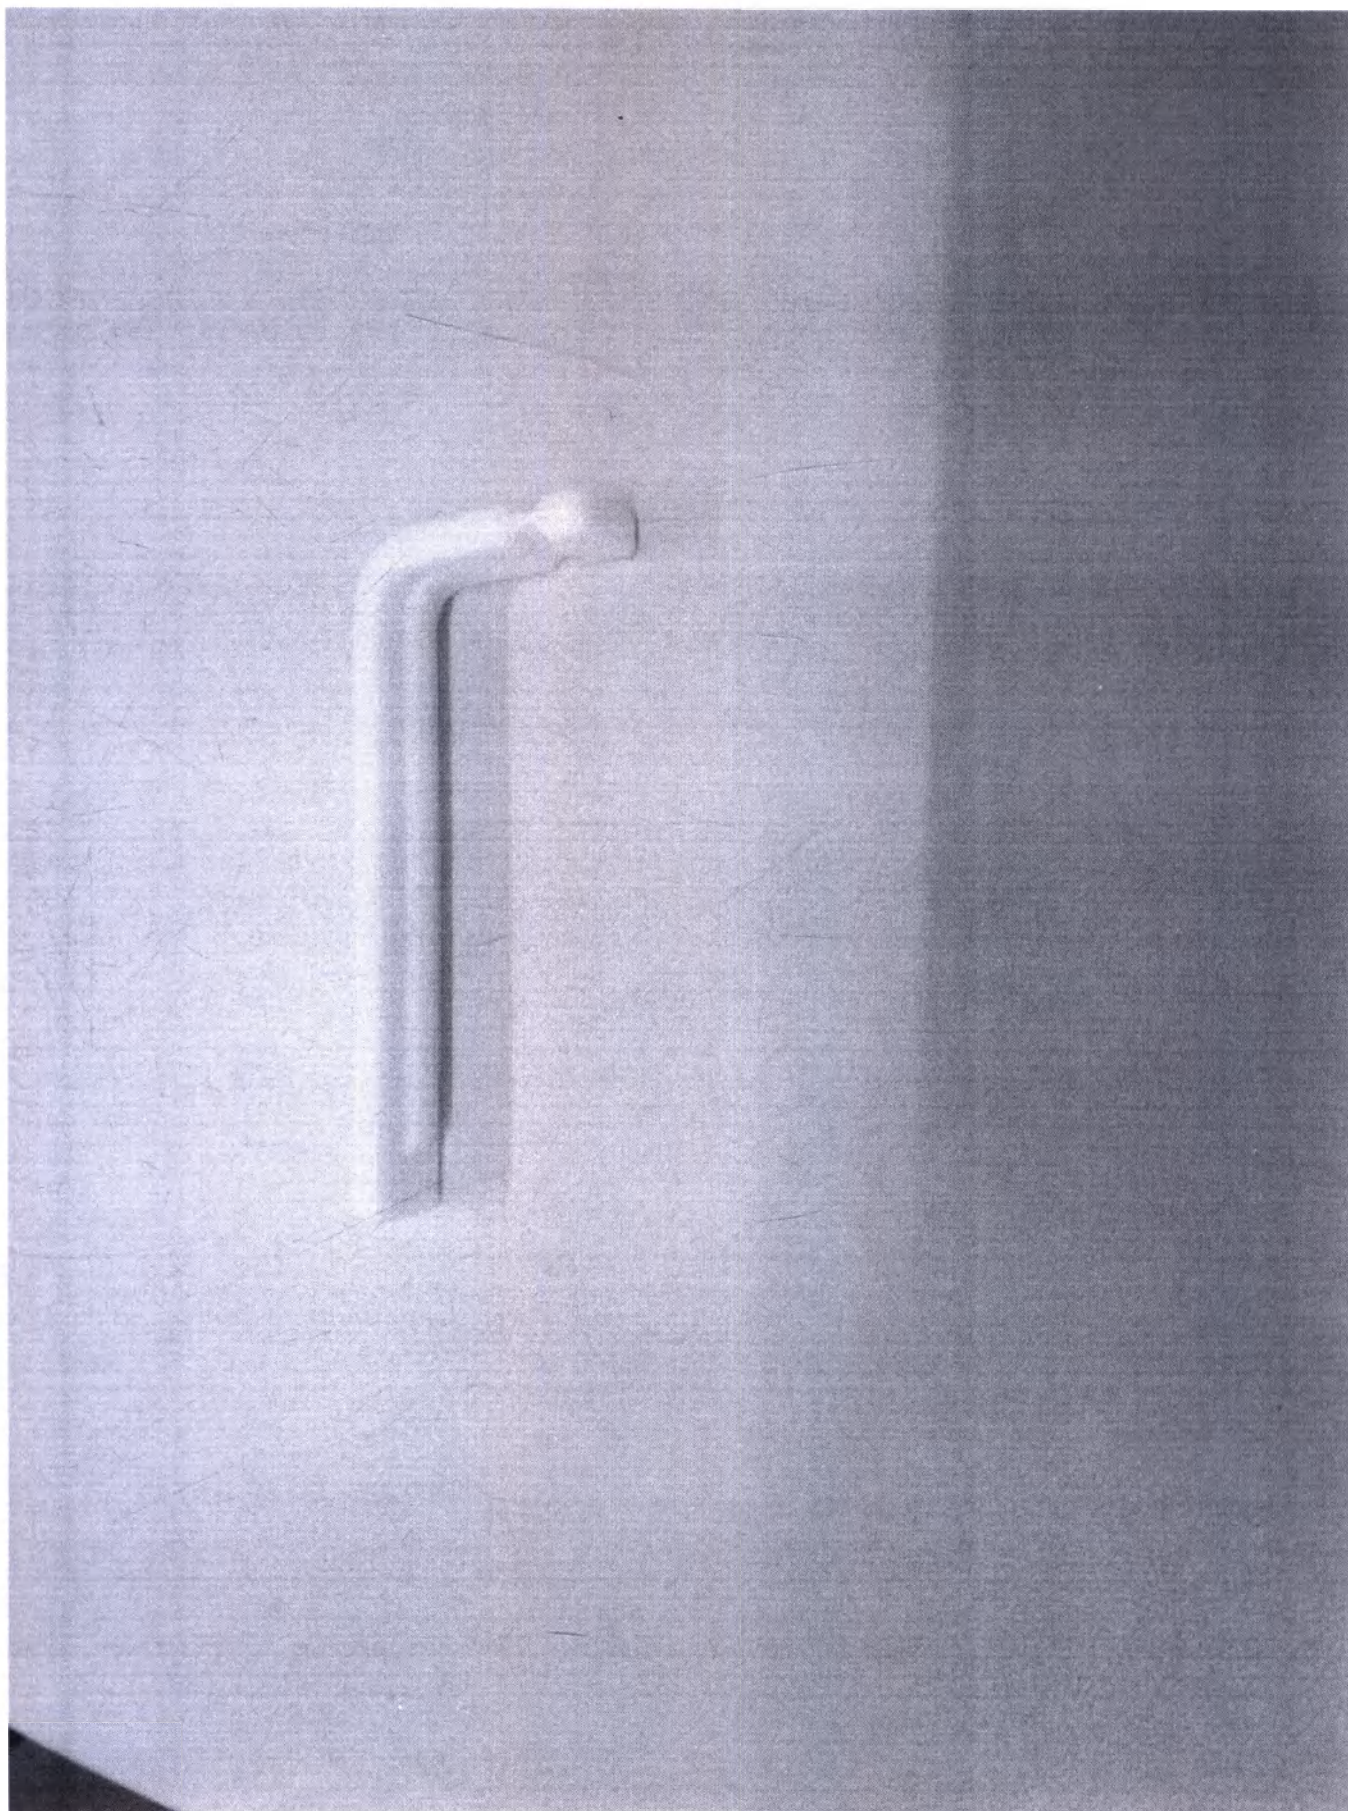


Прикусной блок

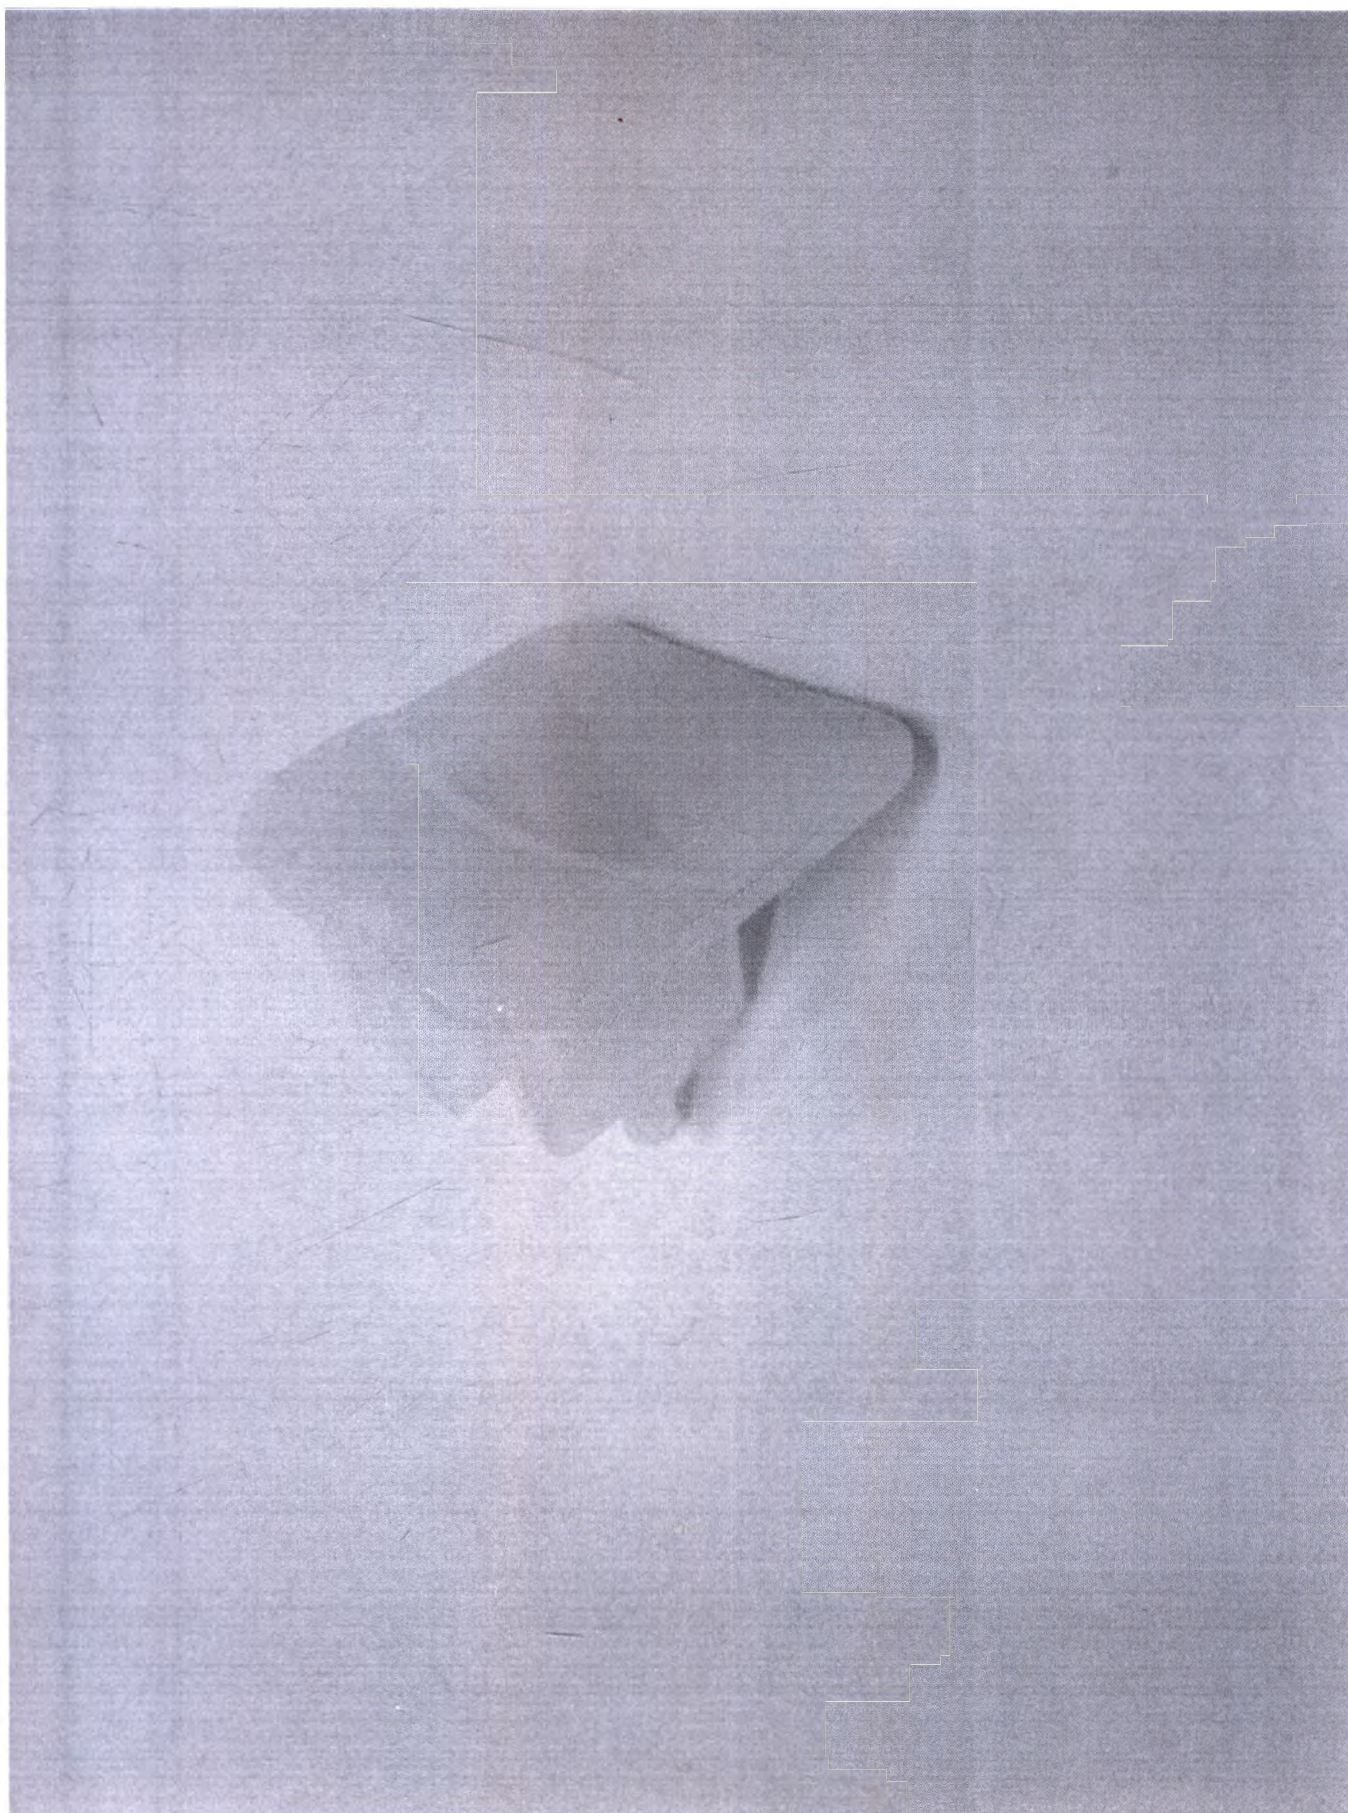


Держатель подбородка для прикусного блока

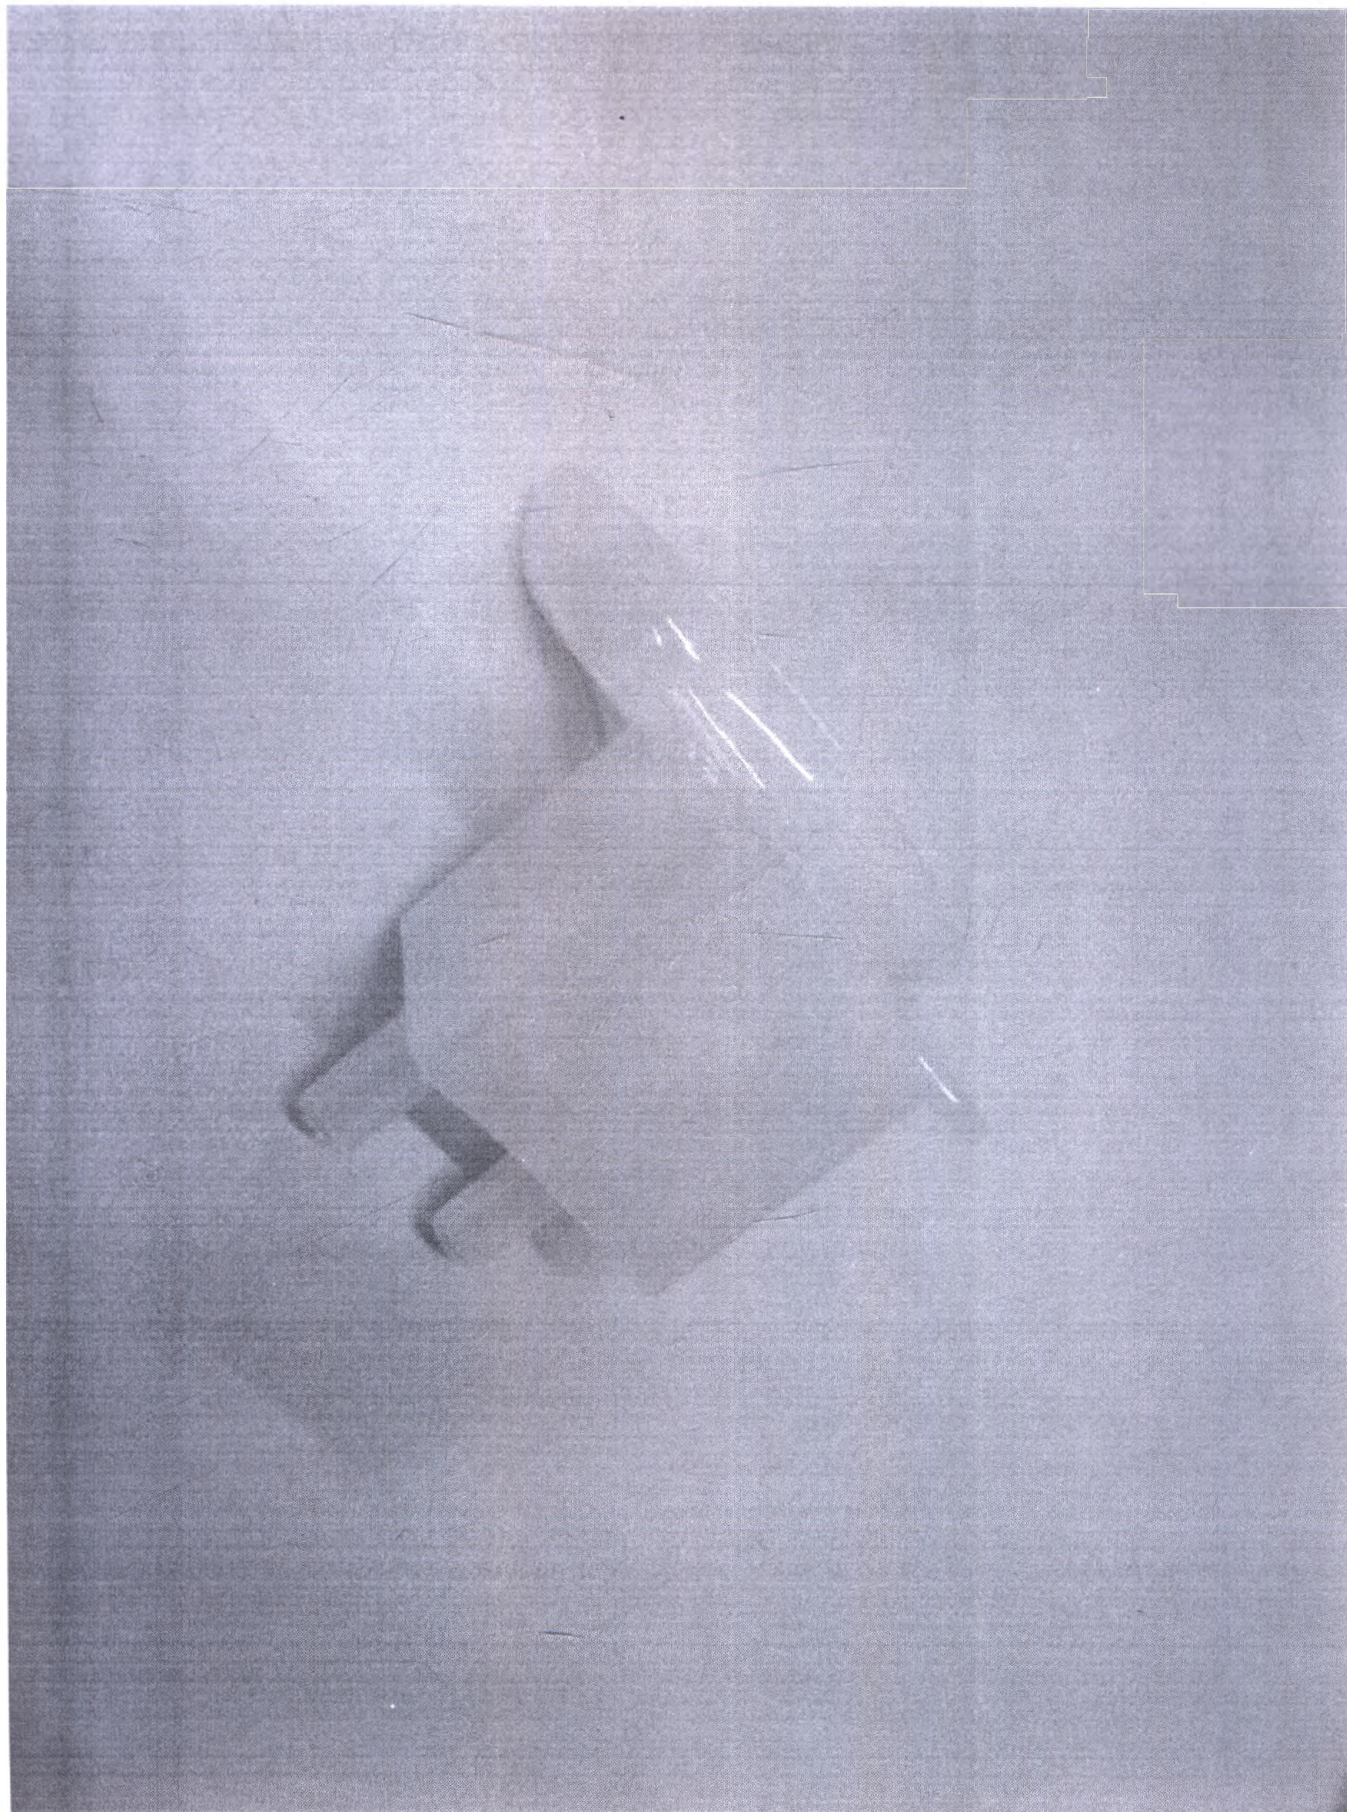


Держатель подбородка для беззубых пациентов

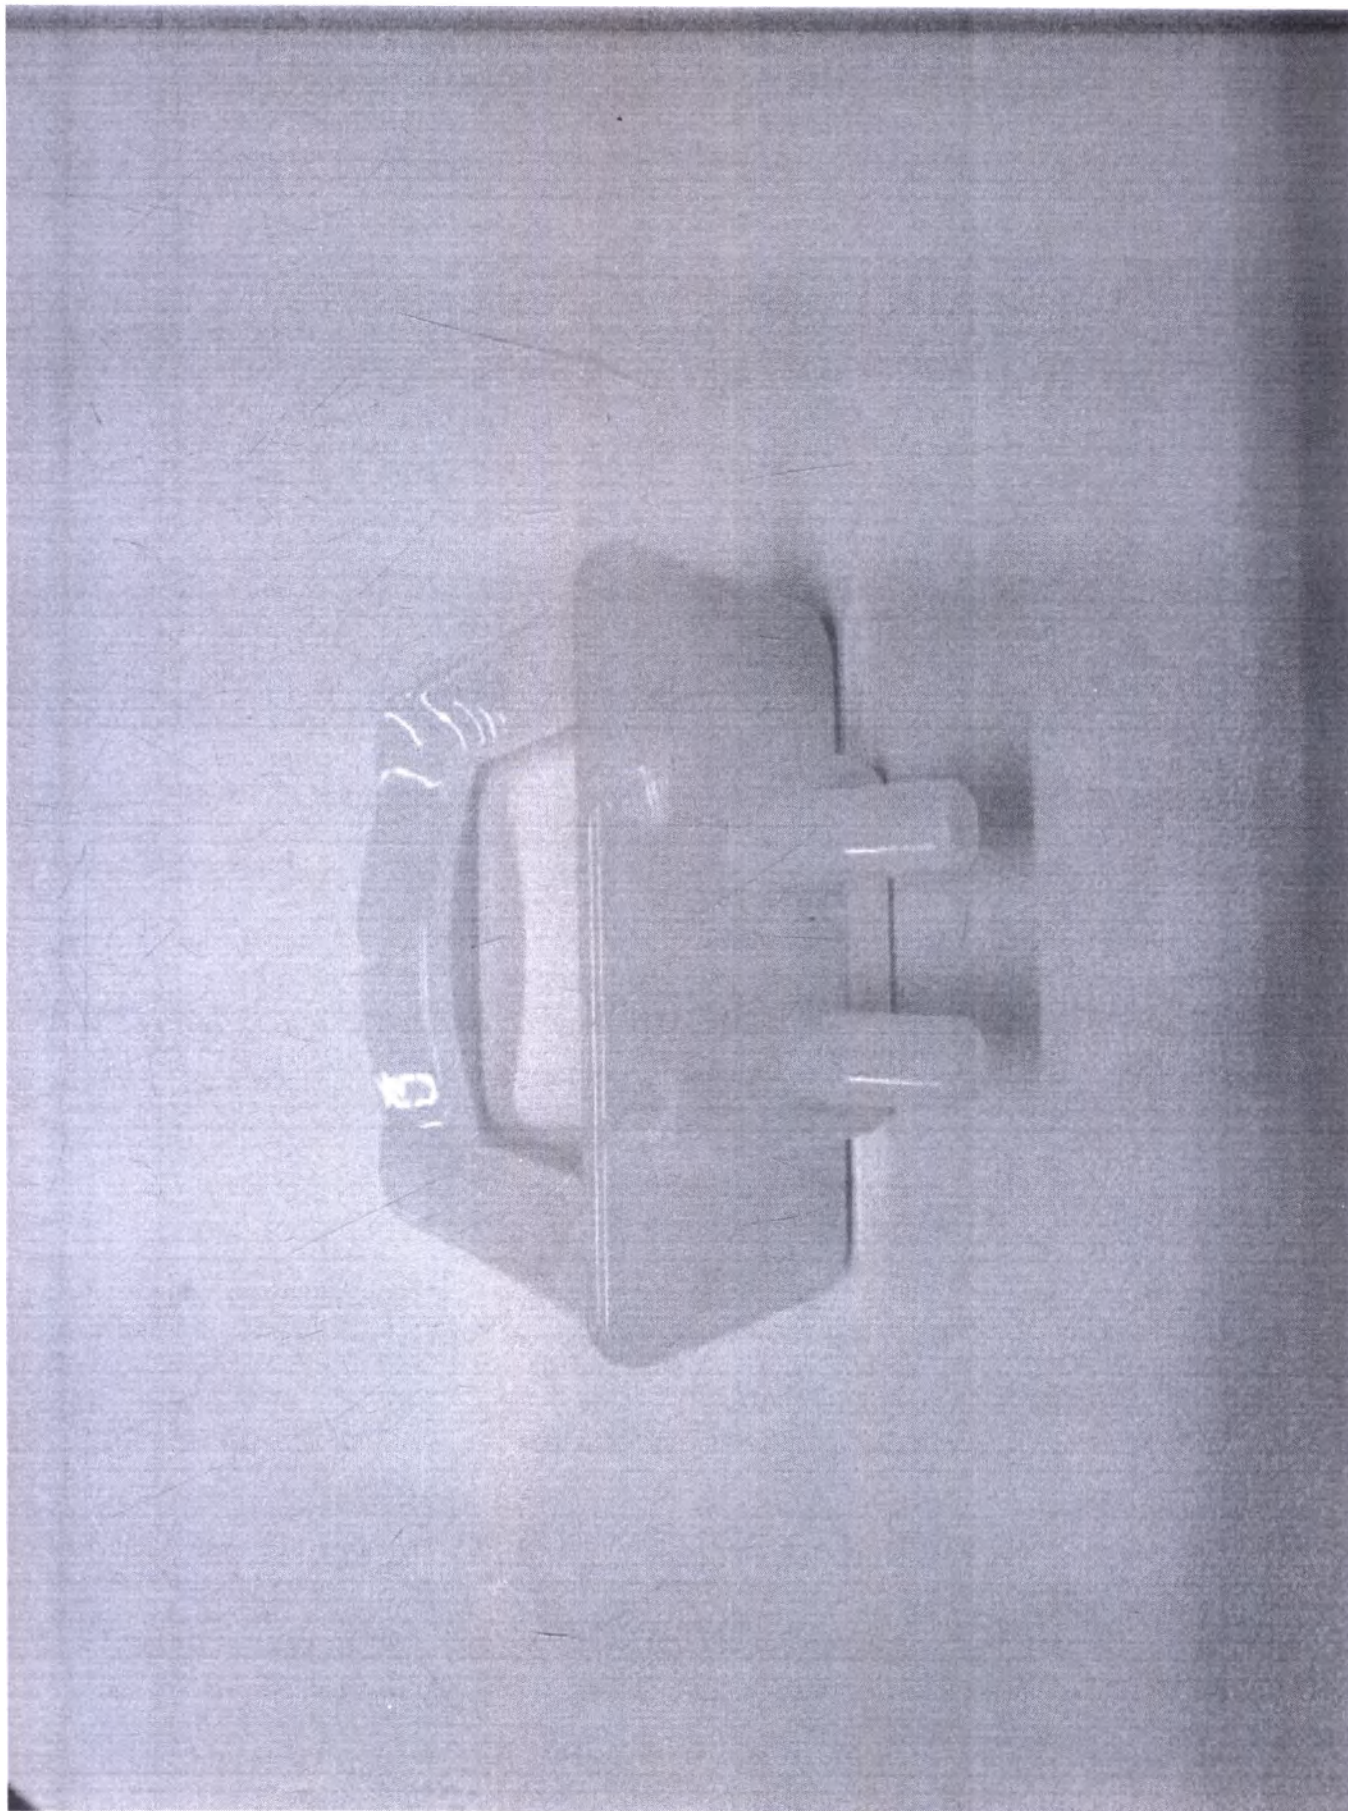

Опора для получения изображения височно-нижнечелюстного сустава

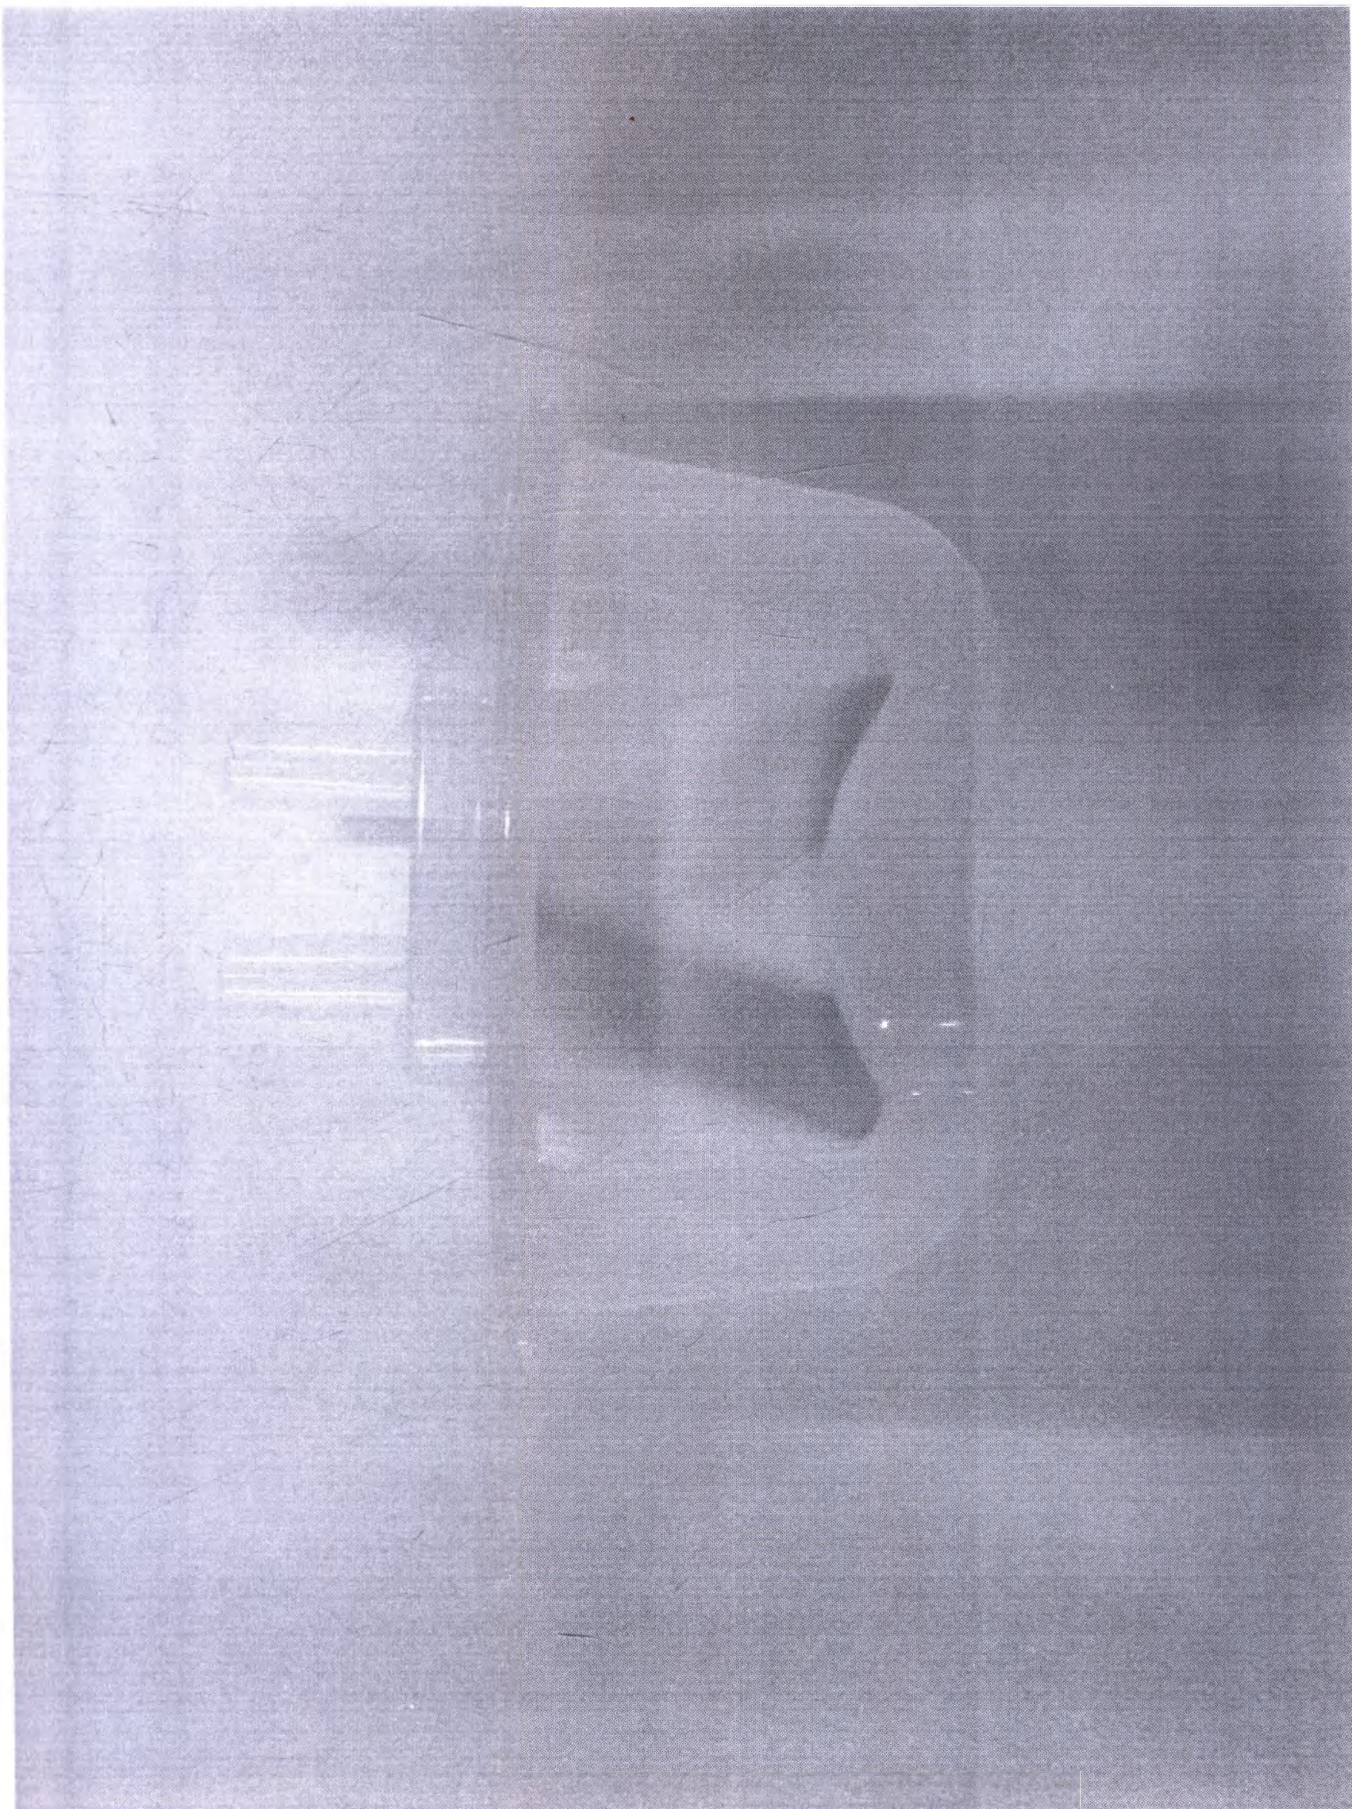

Опора для получения изображения верхнечелюстной пазухи

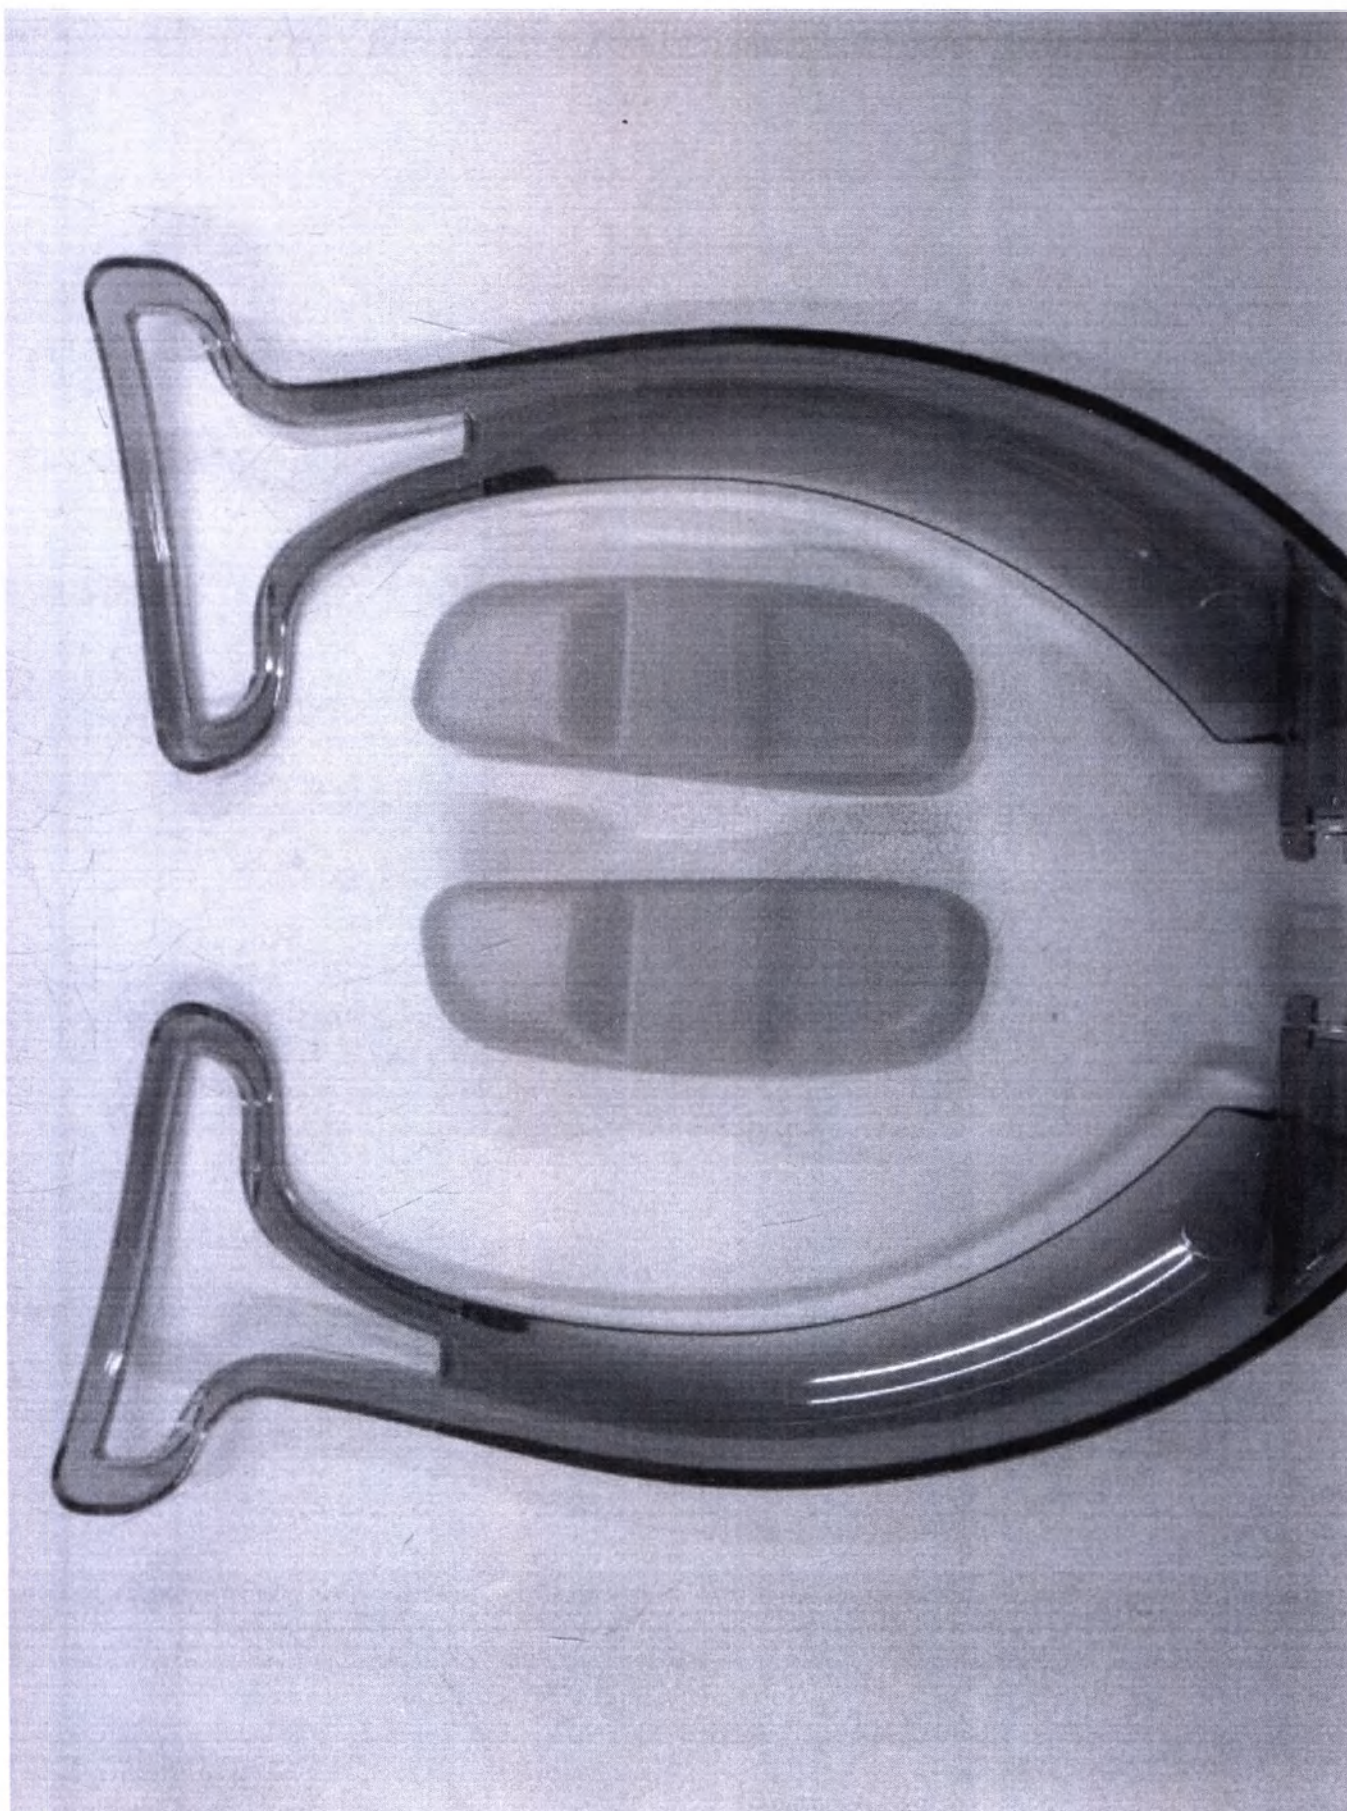


Височный держатель с подушками

VistaSoft

Программное обеспечение


Version: 1.0

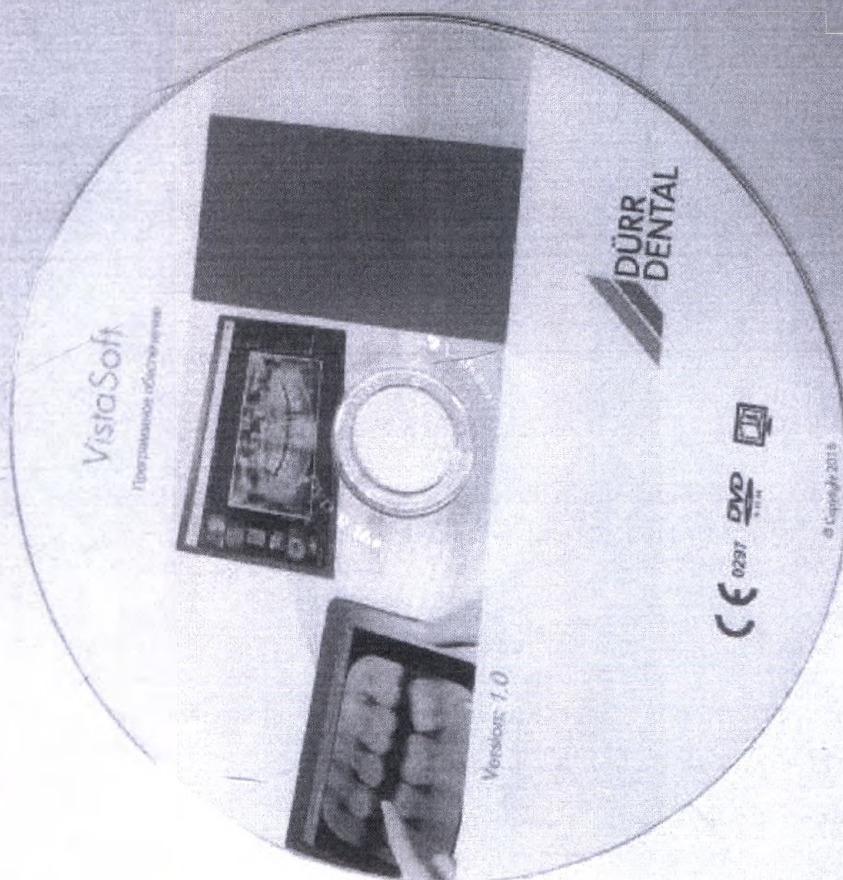


Диск с программным обеспечением для обработки изображений VistaSoft



Оптический кабель 10 м

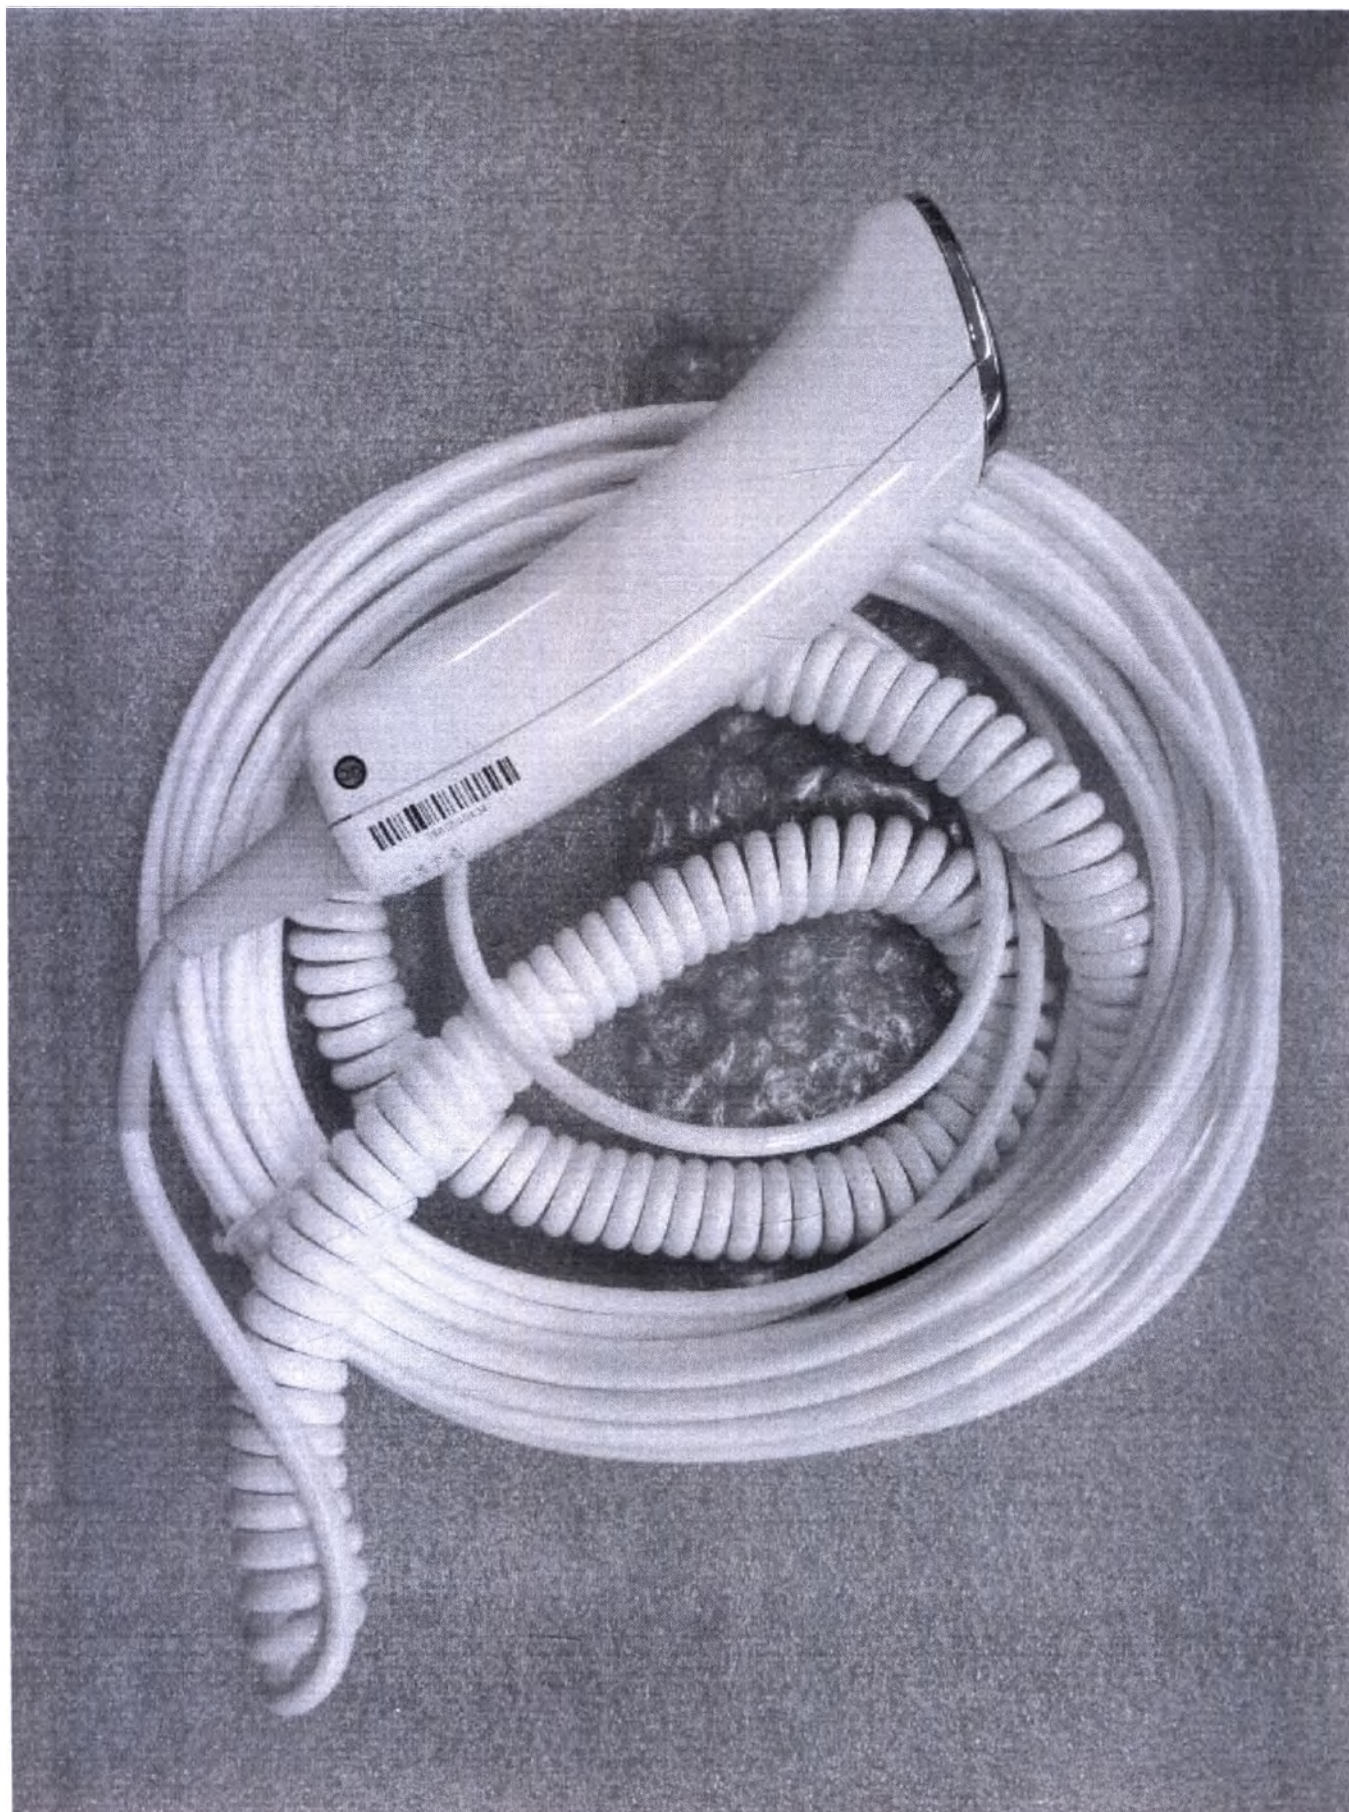


Пульт дистанционного управления

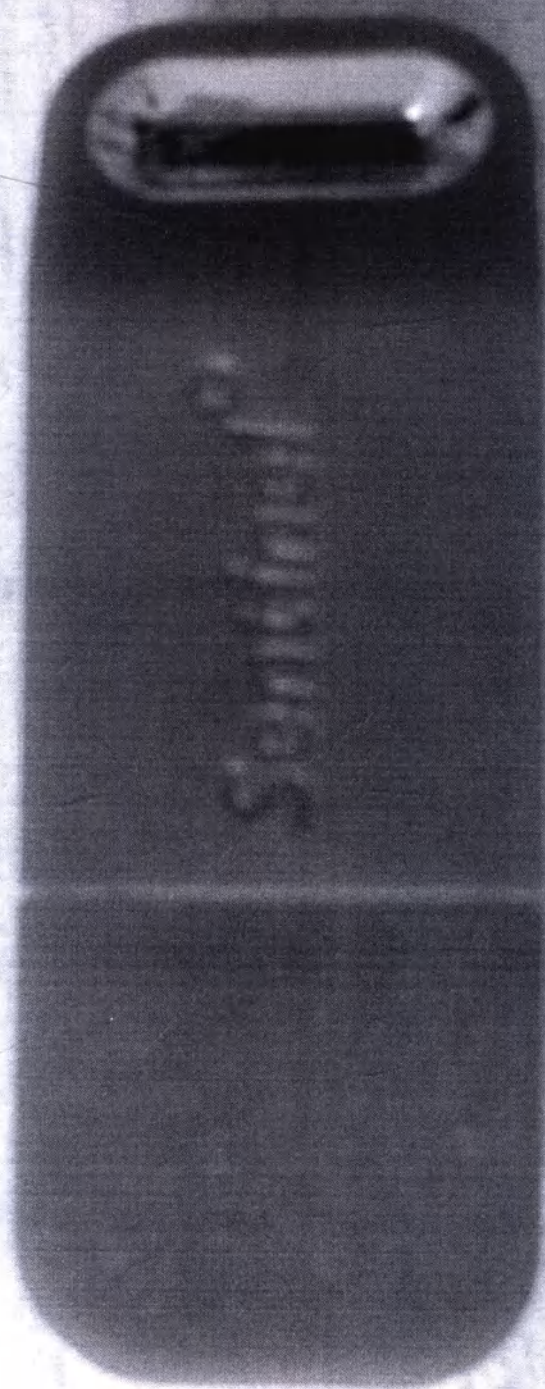

USB-ключ для активации 3D-реконструкции




USB-накопитель с данными калибровки для устройства

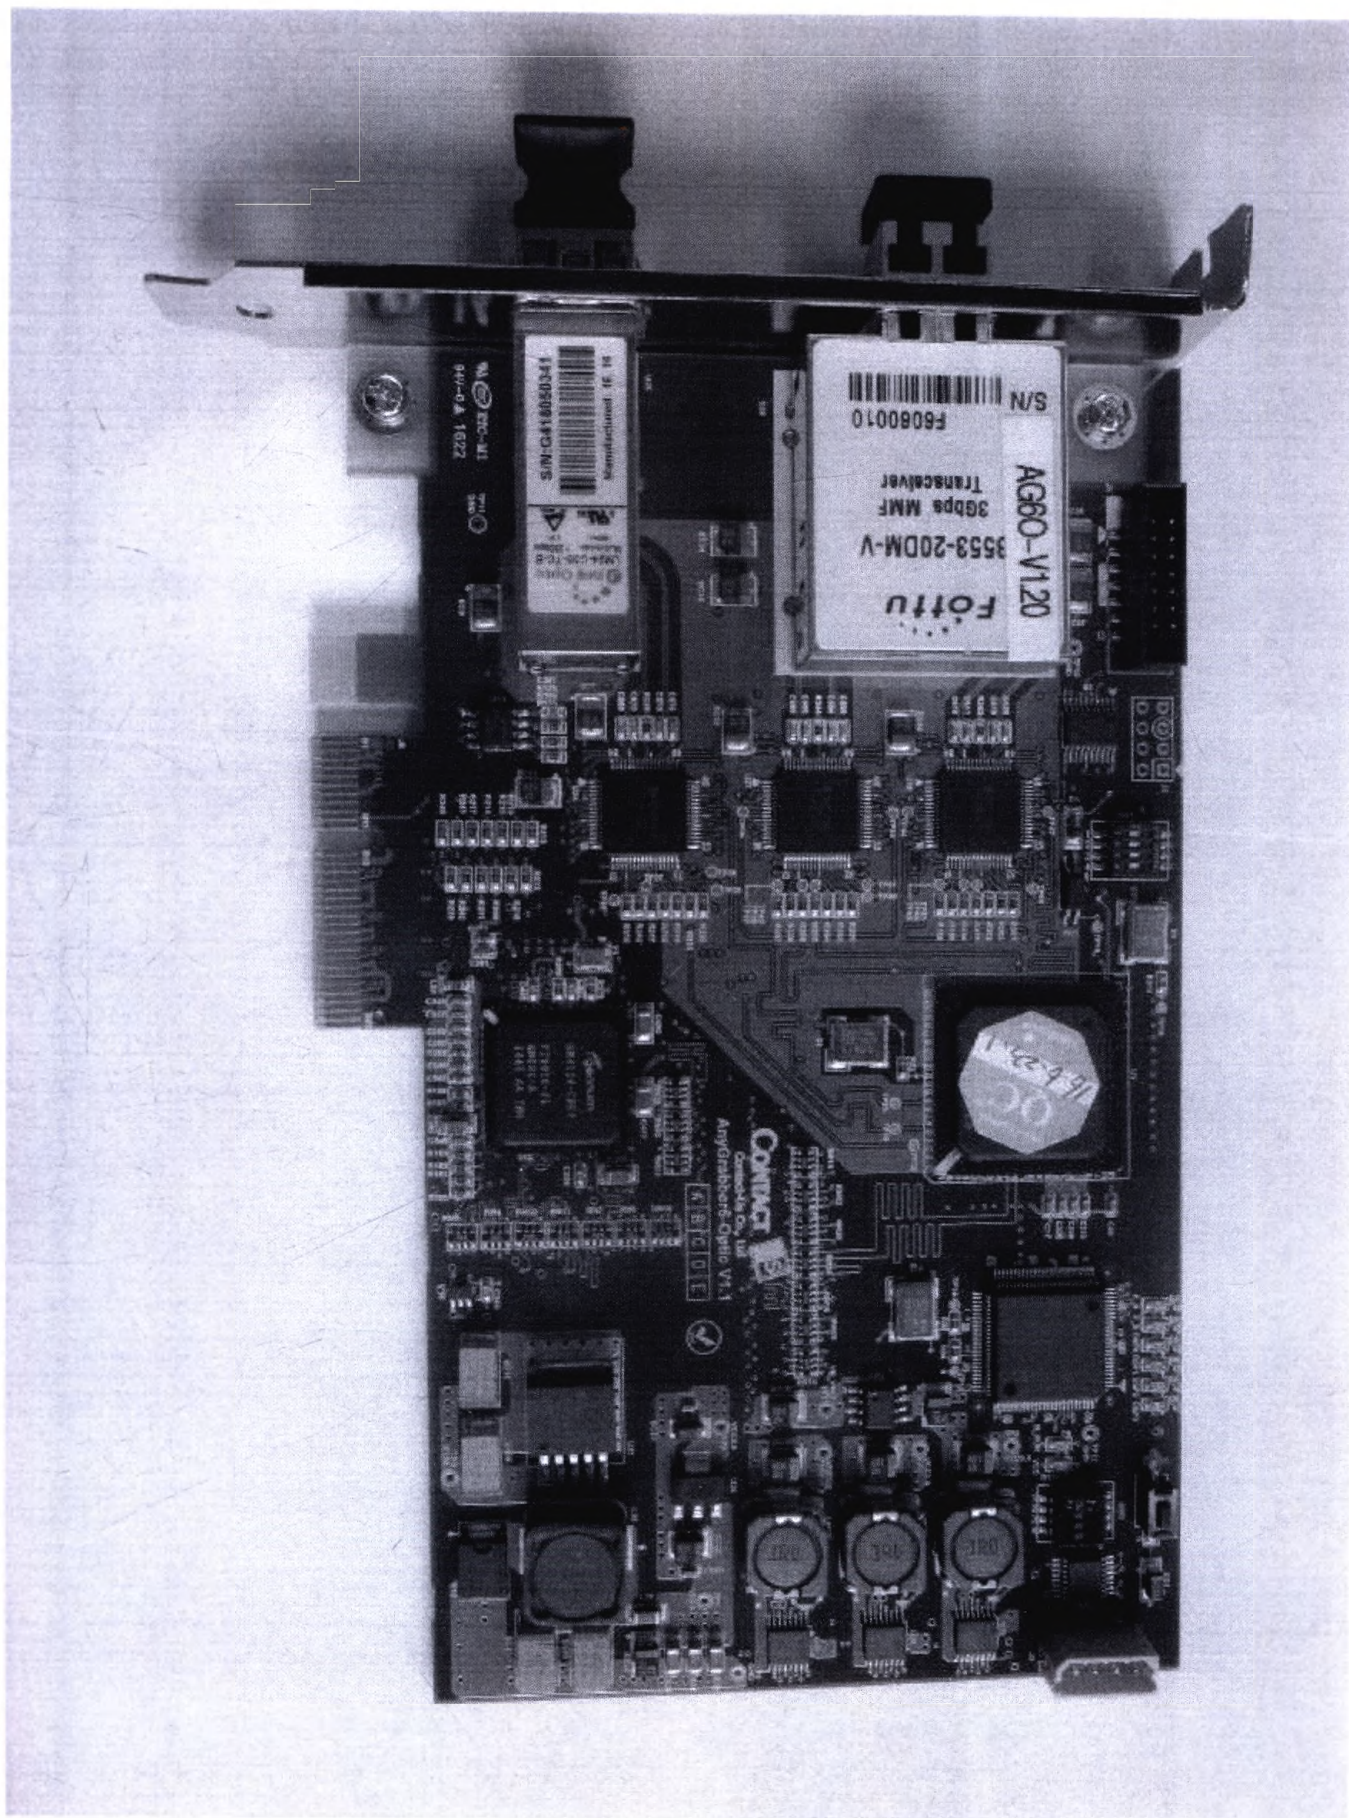


Карта PCI для видео захвата




Комплект деталей

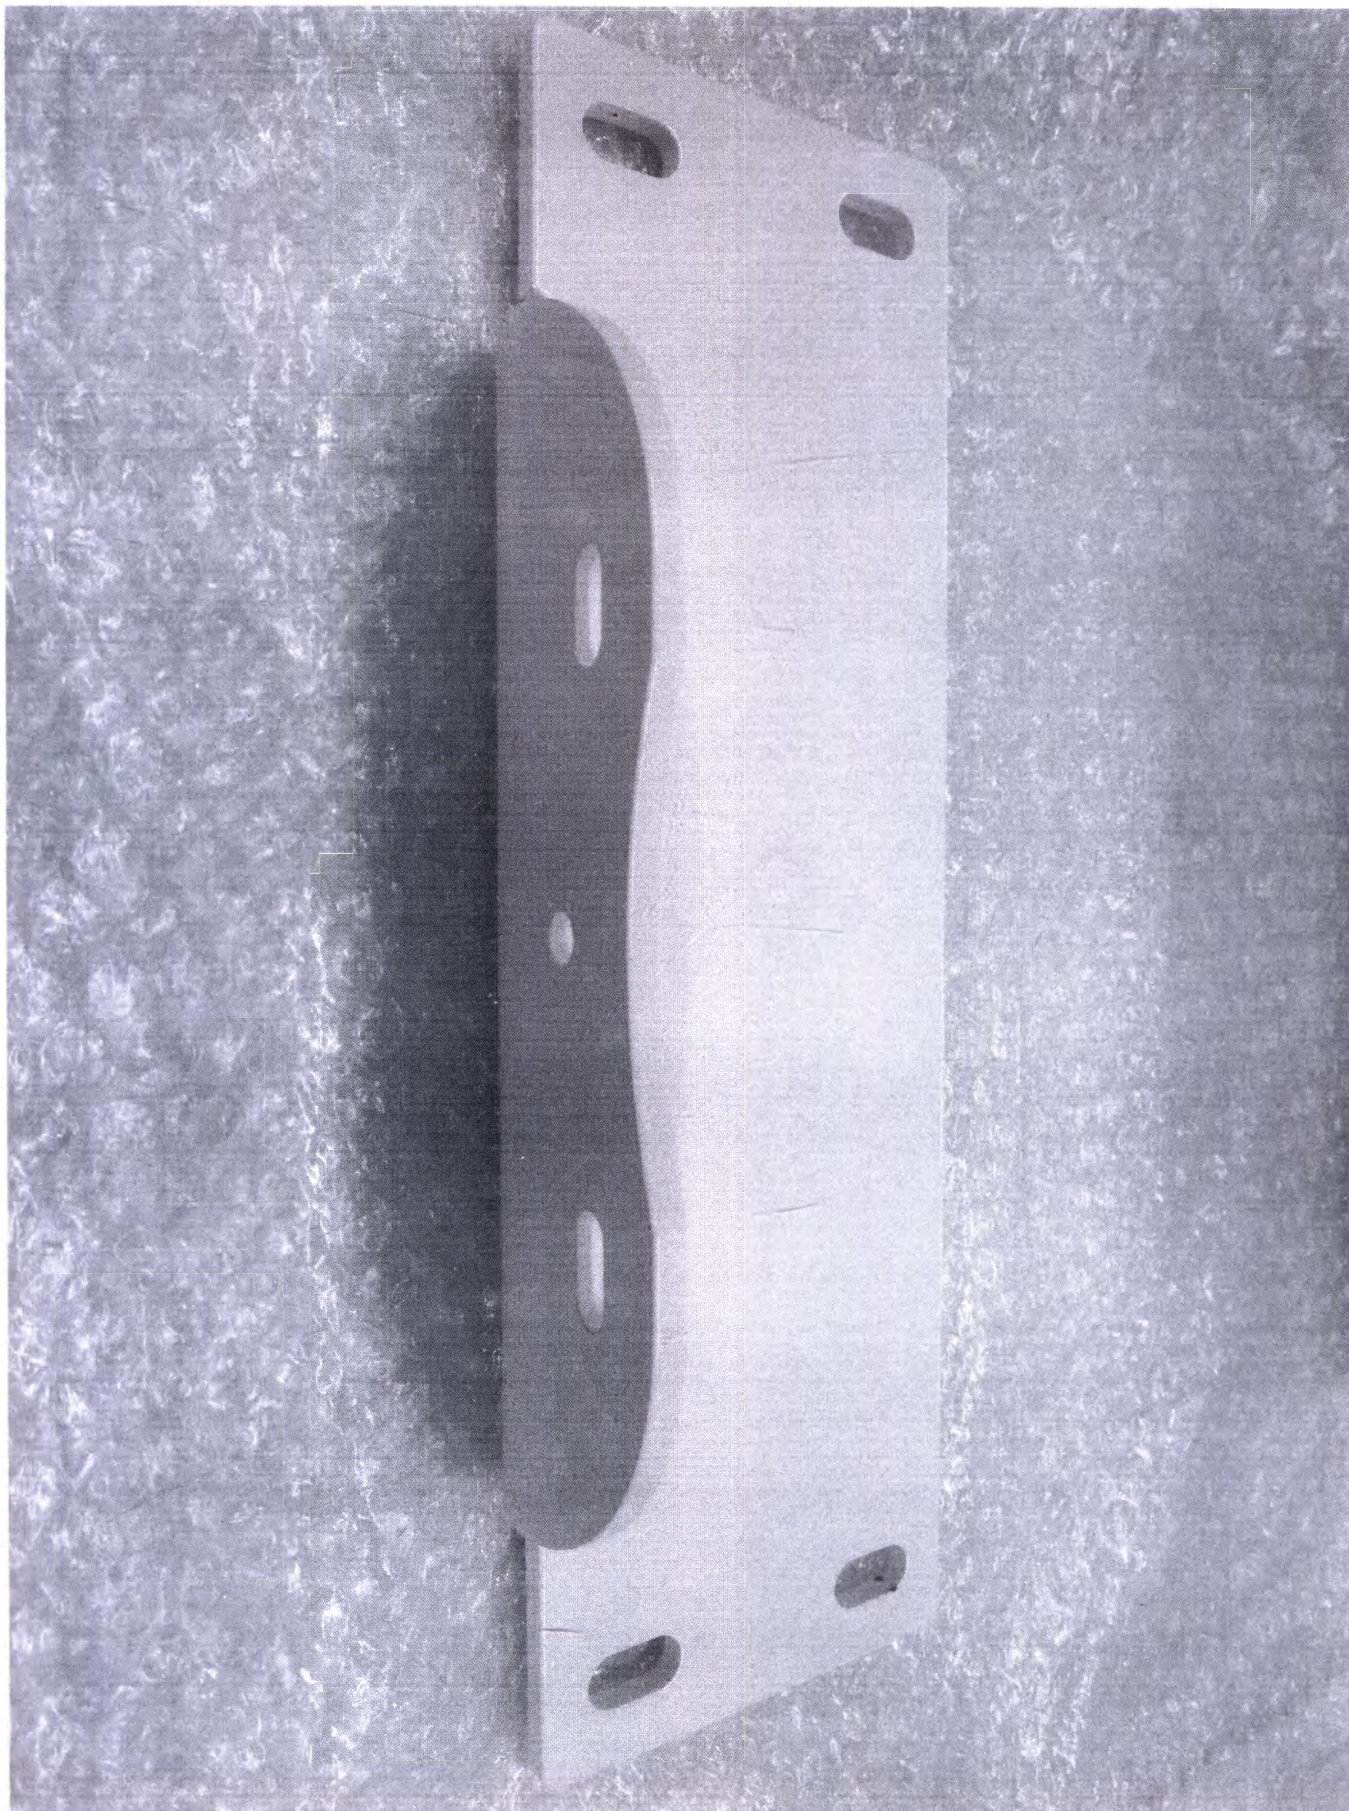


Верхний длинный настенный кронштейн

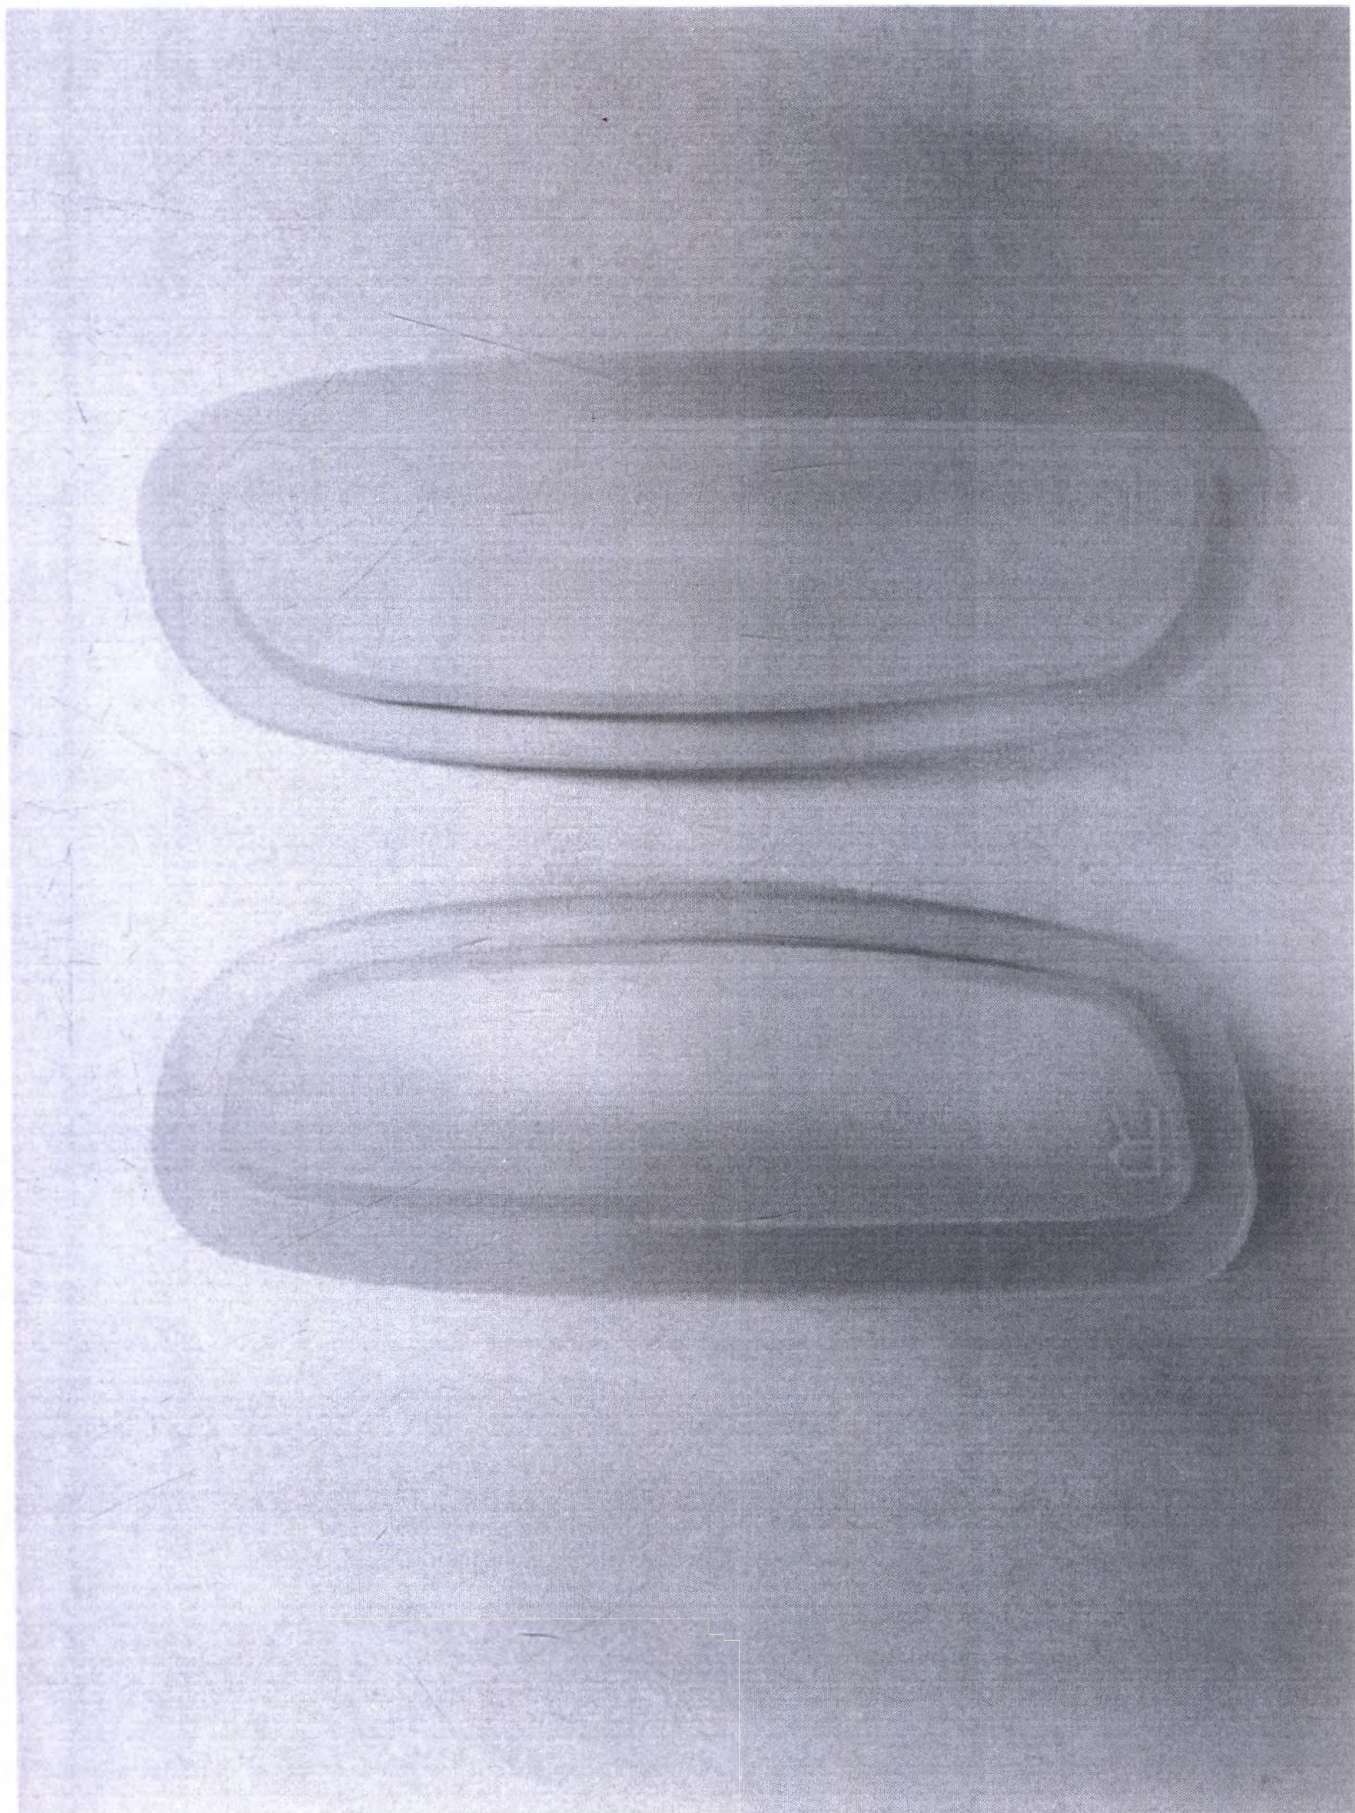


Подушечки для поддержки головы левая и правая

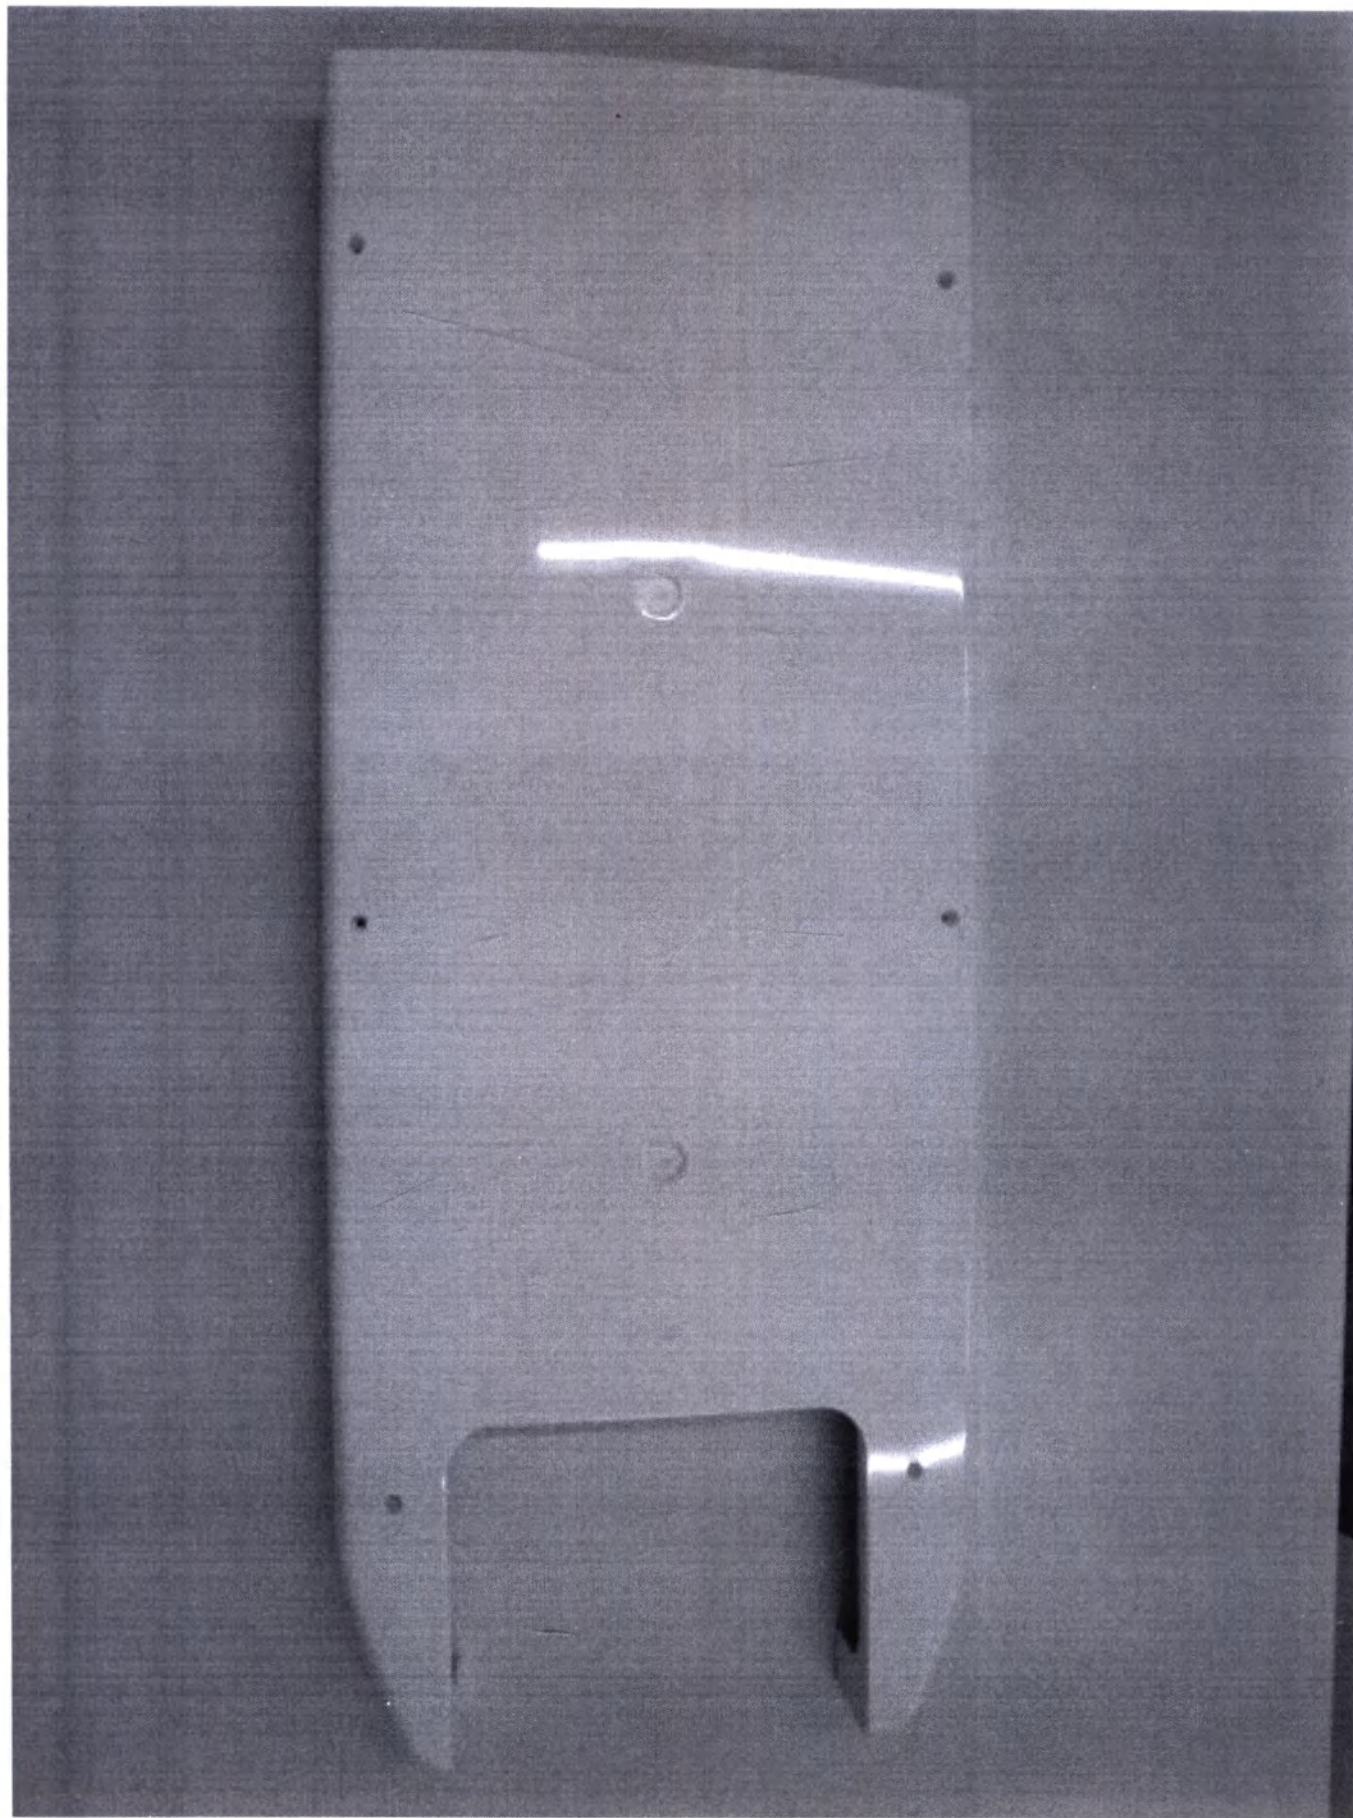


Верхняя часть корпуса

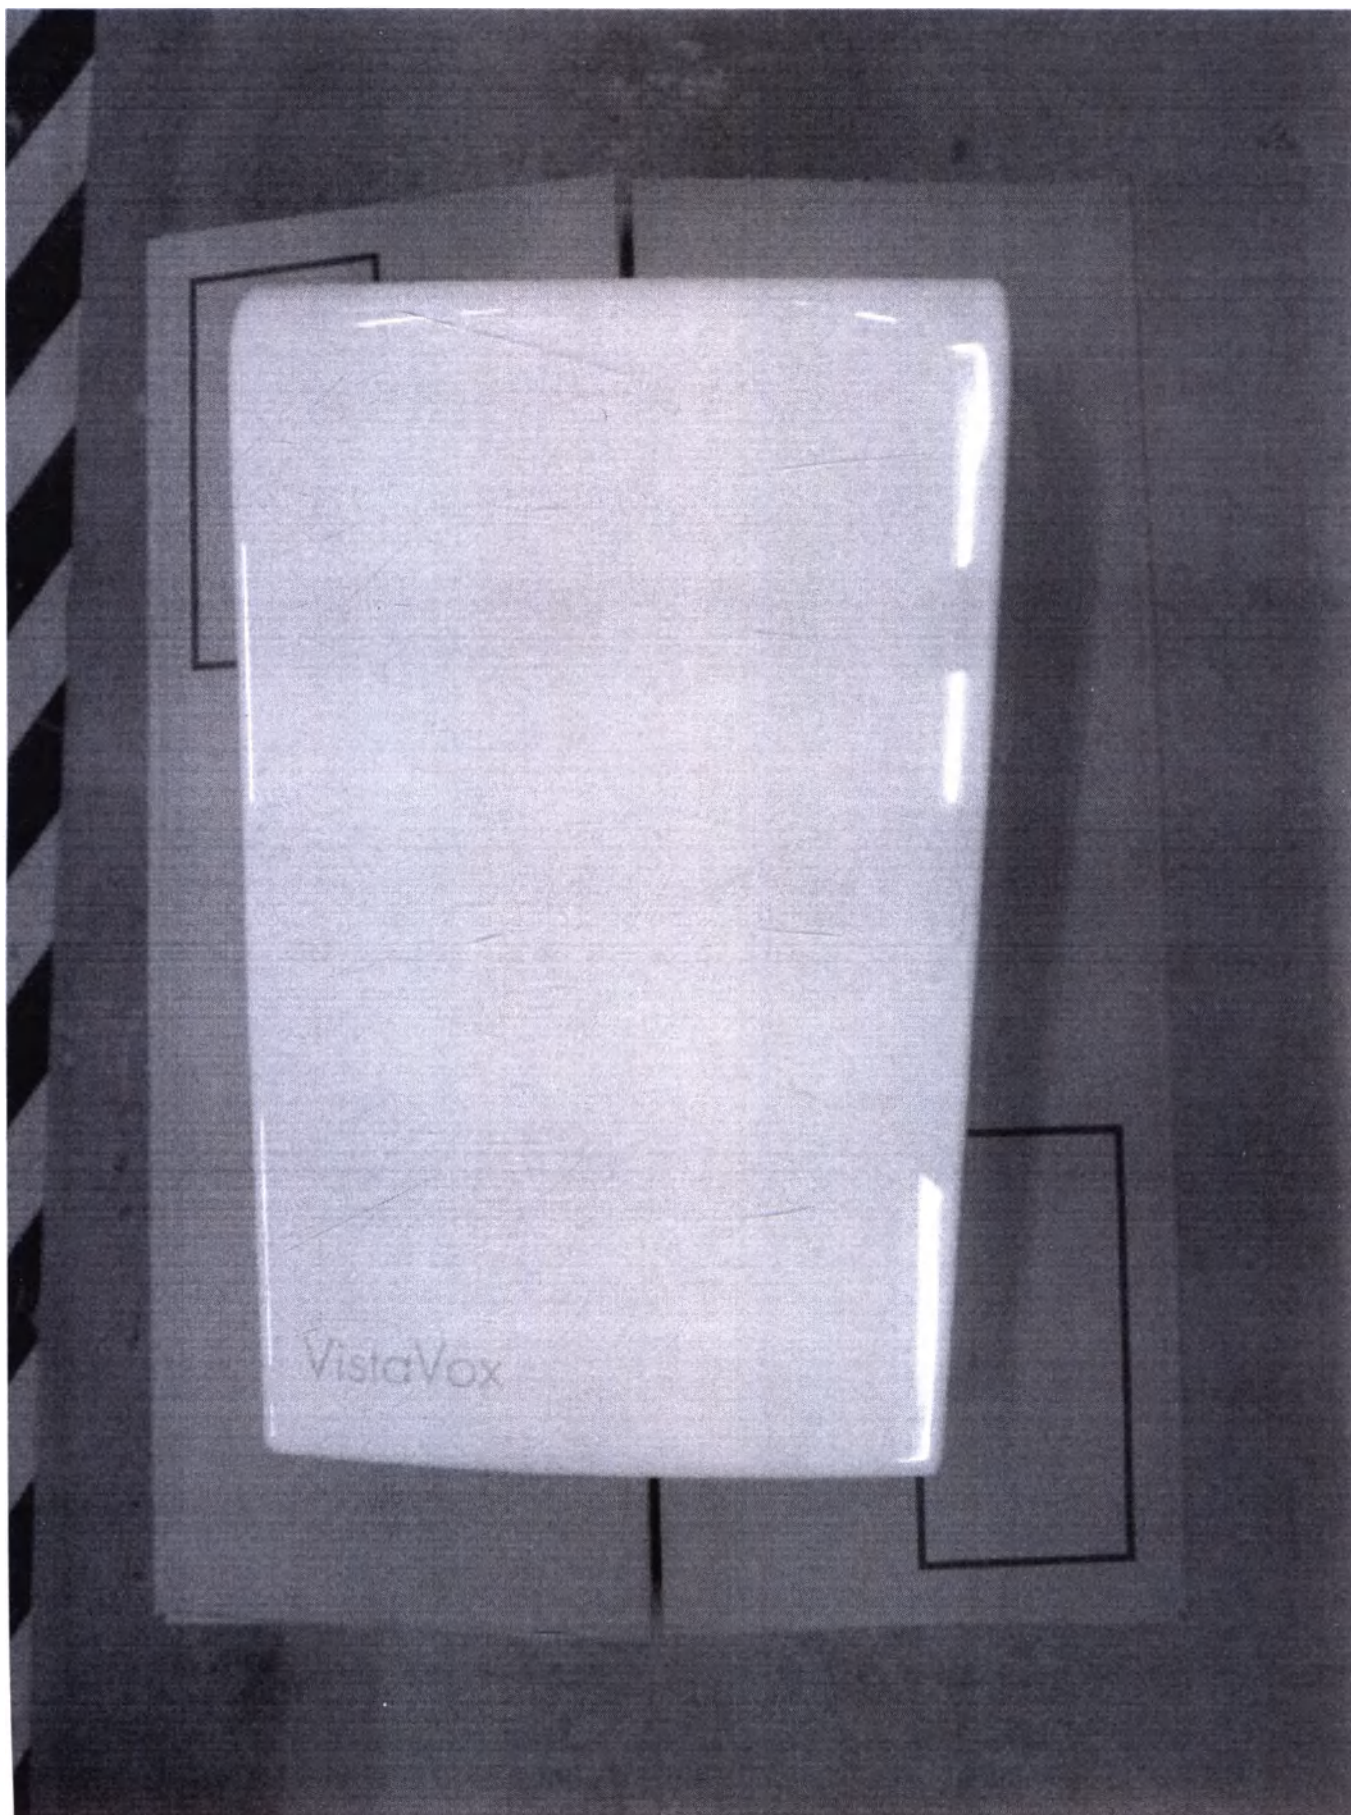


Нижняя передняя часть корпуса

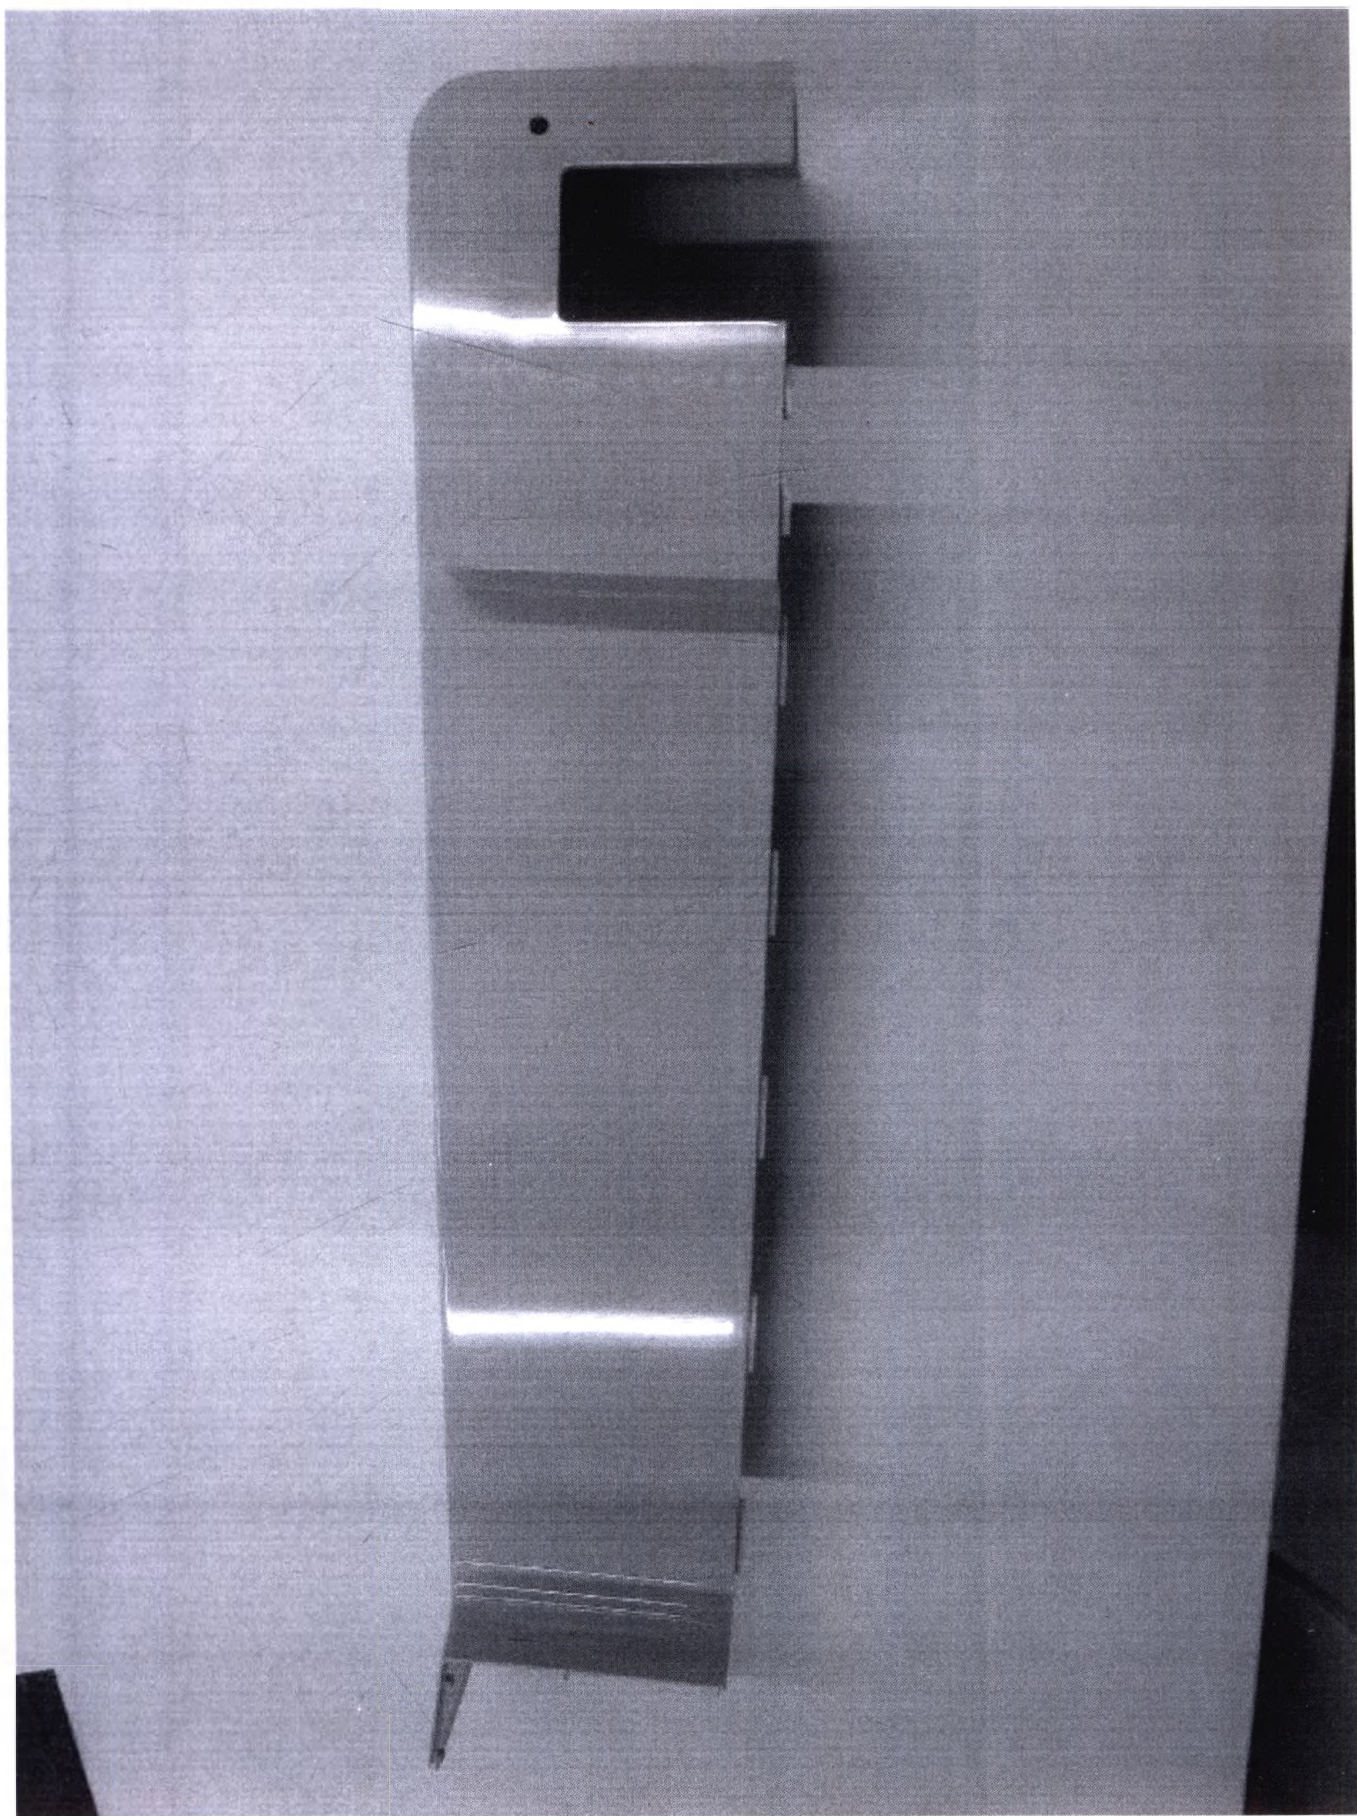


Нижняя левая часть корпуса

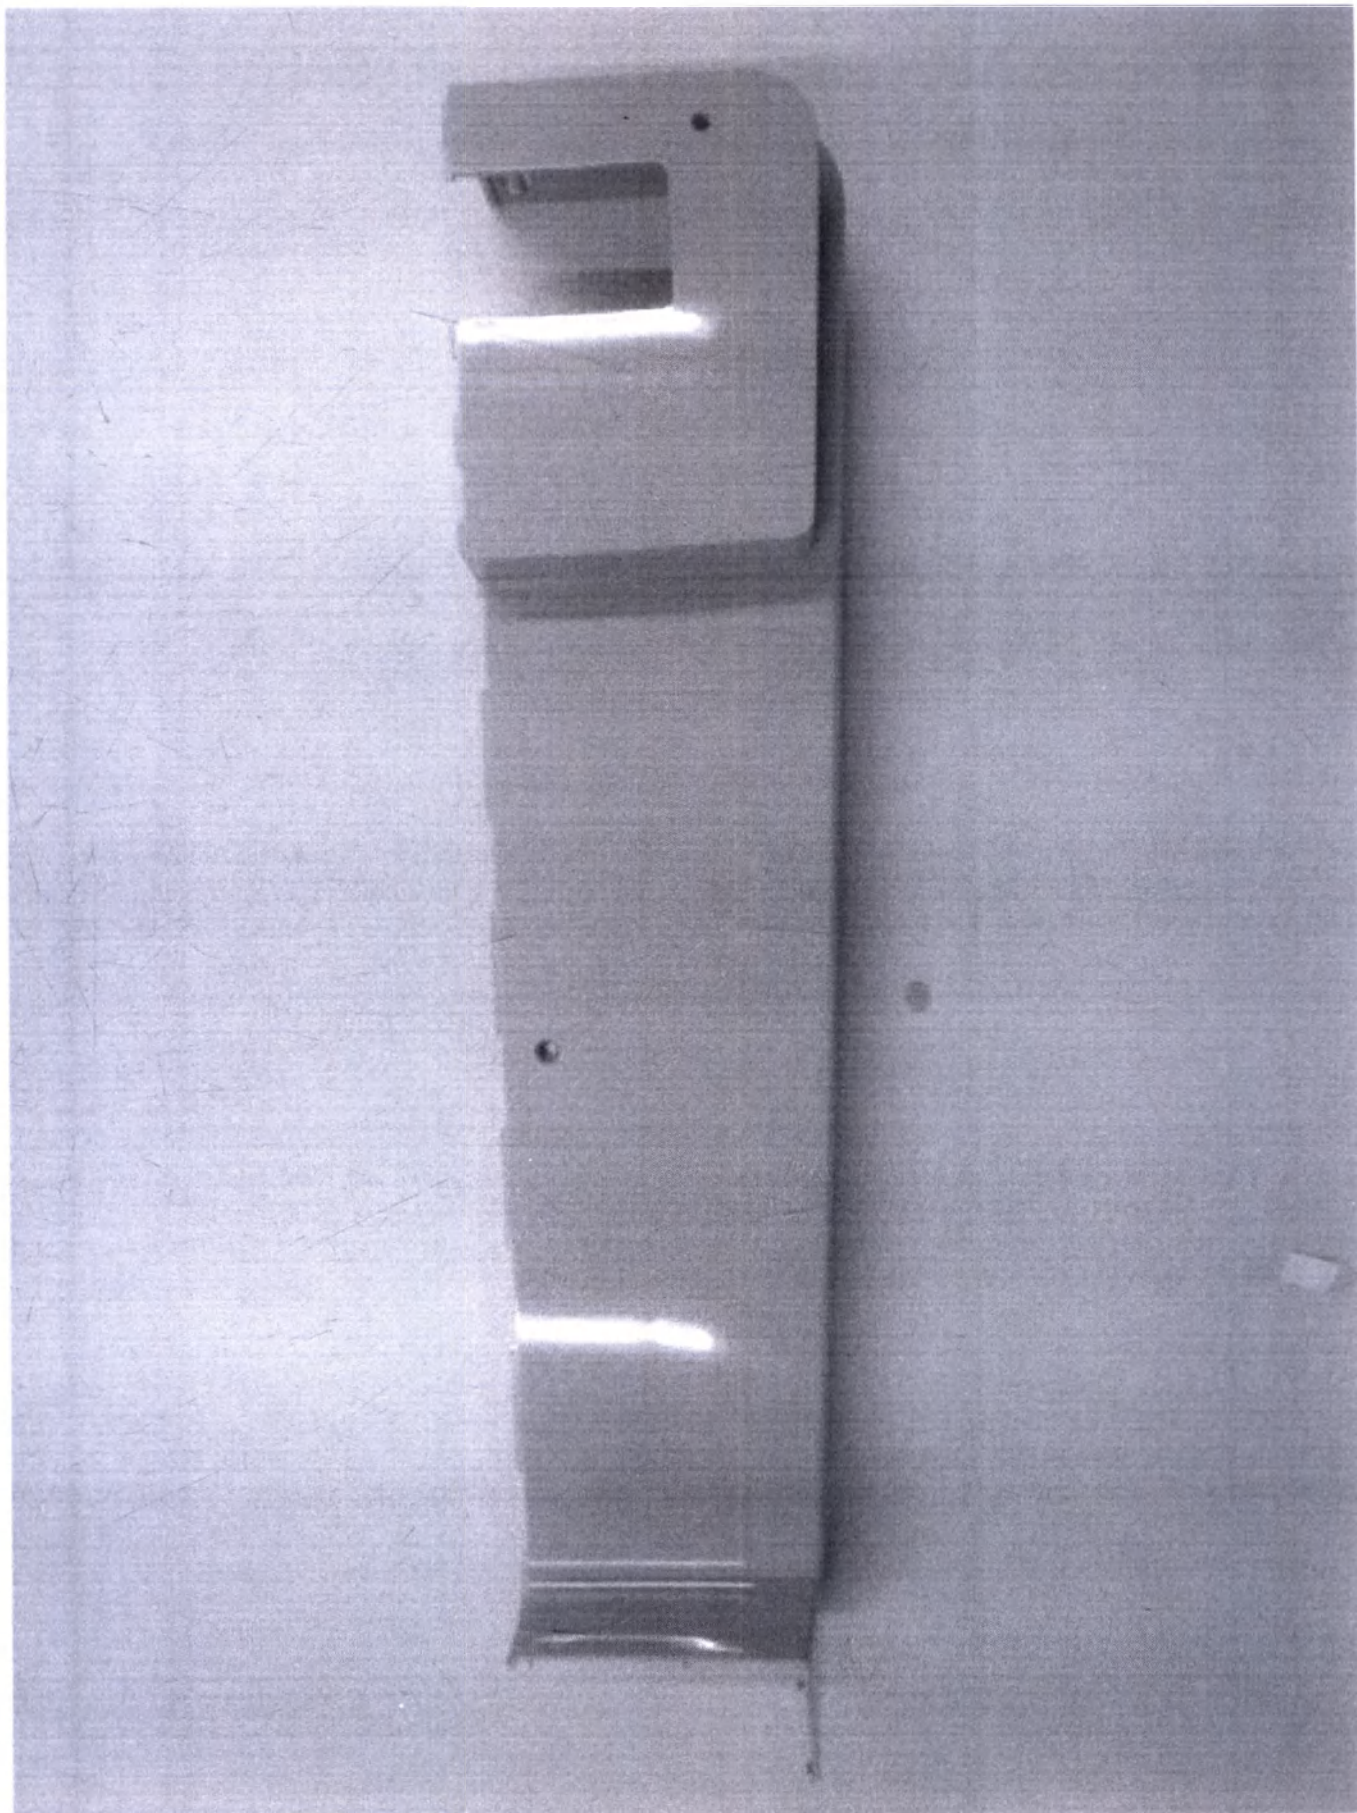


Нижняя правая часть корпуса

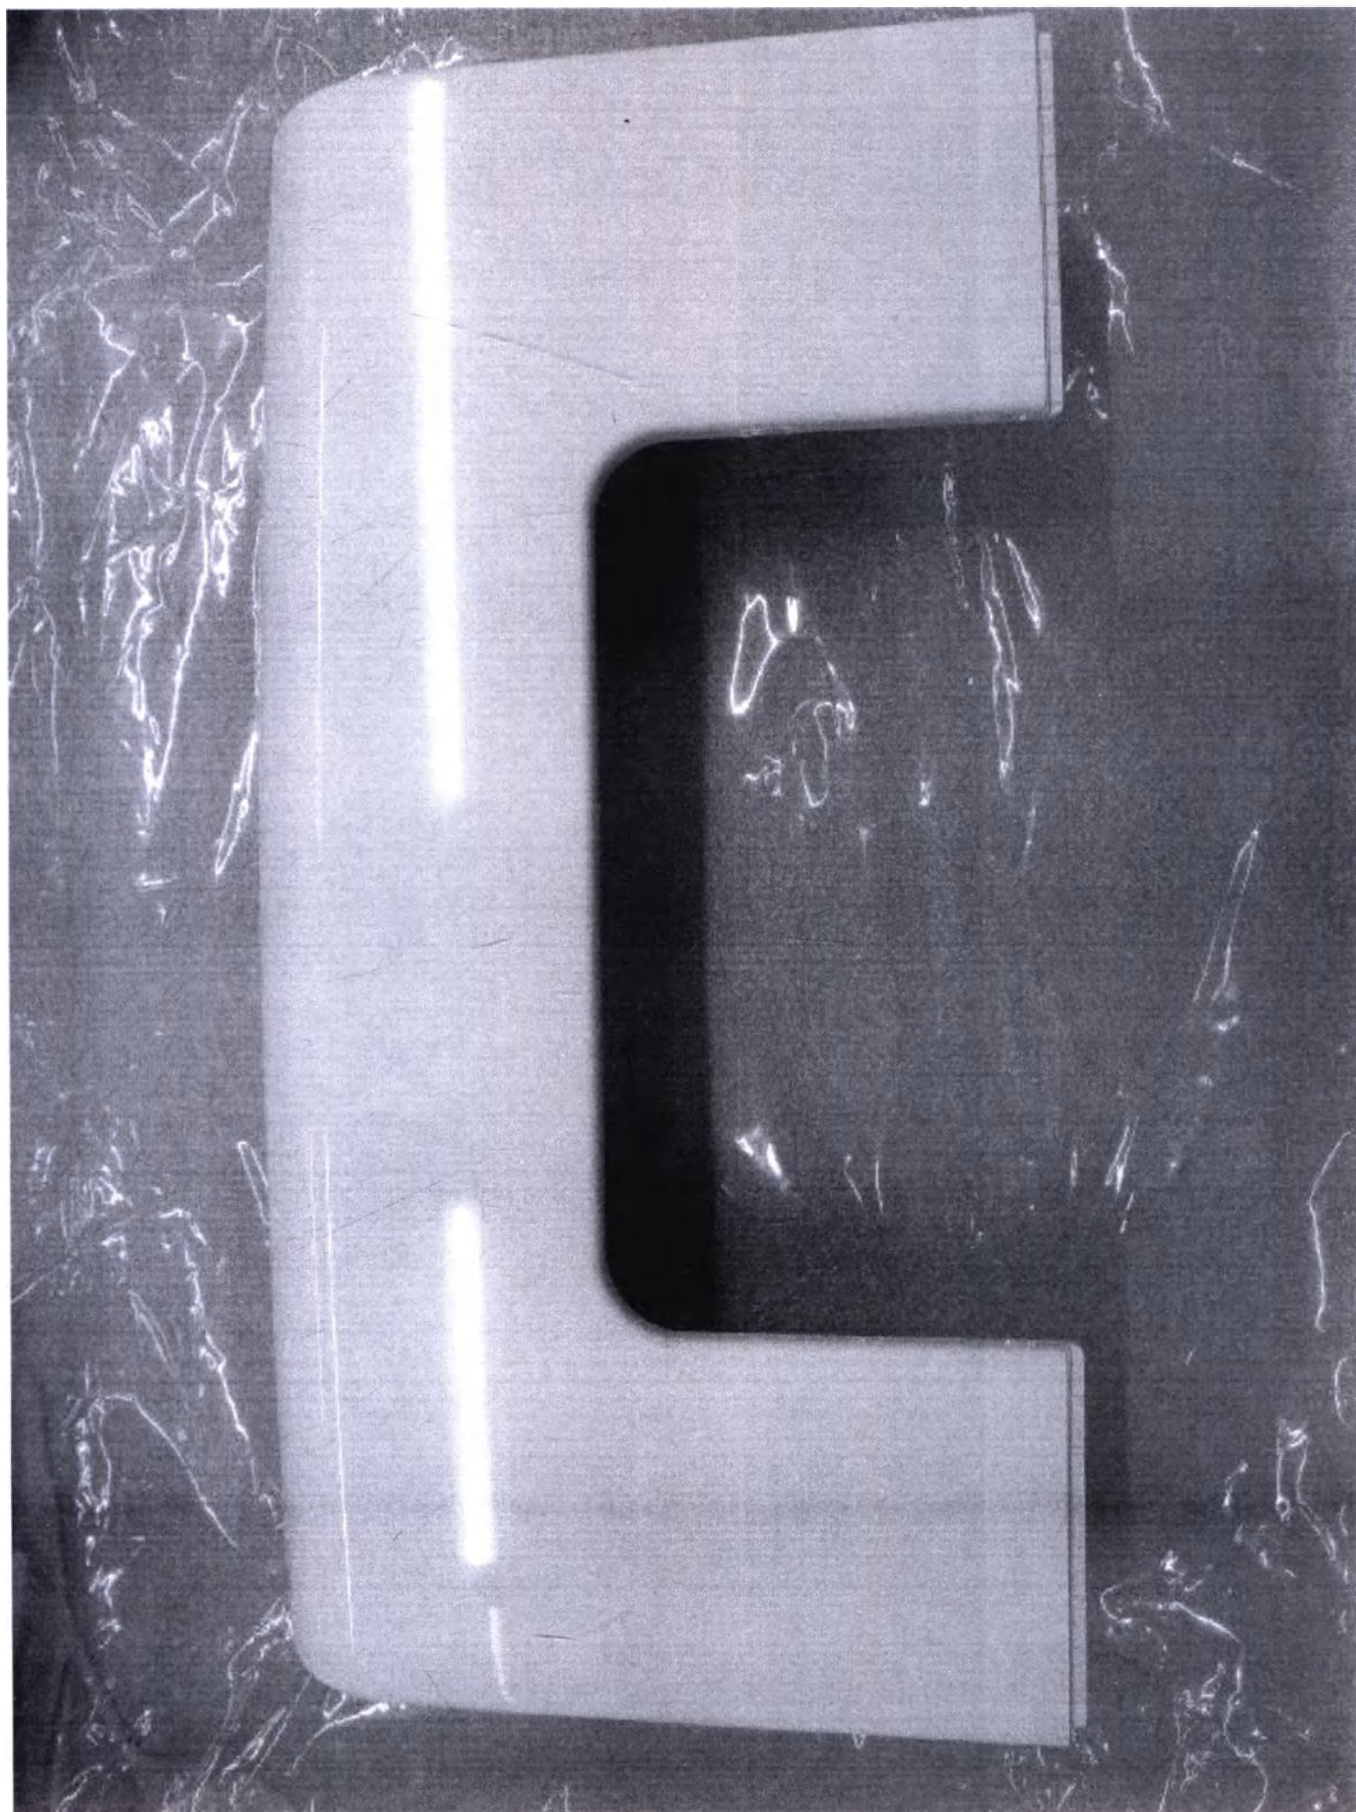


Верхняя малая часть корпуса

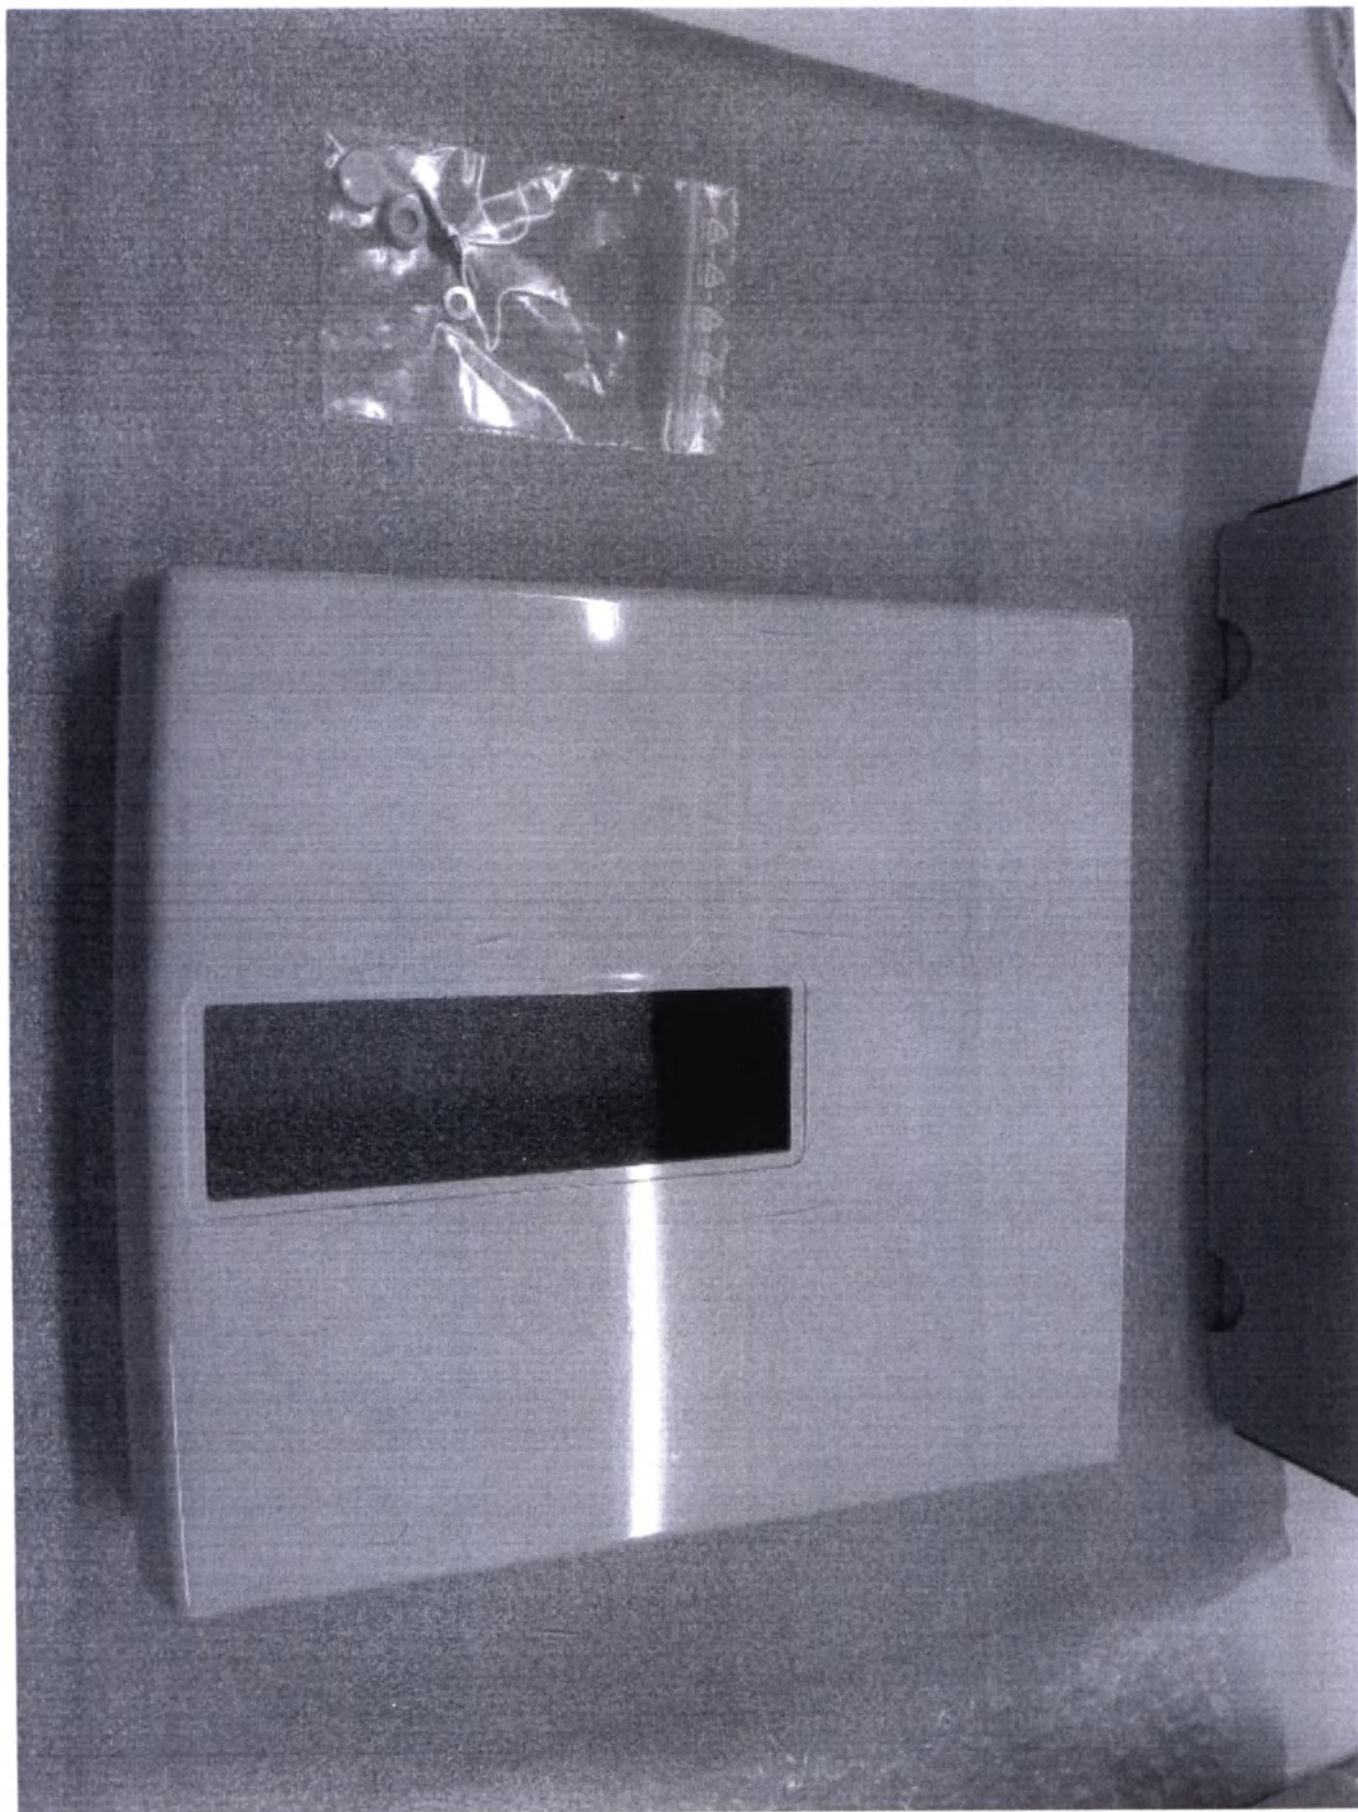

Часть корпуса датчика

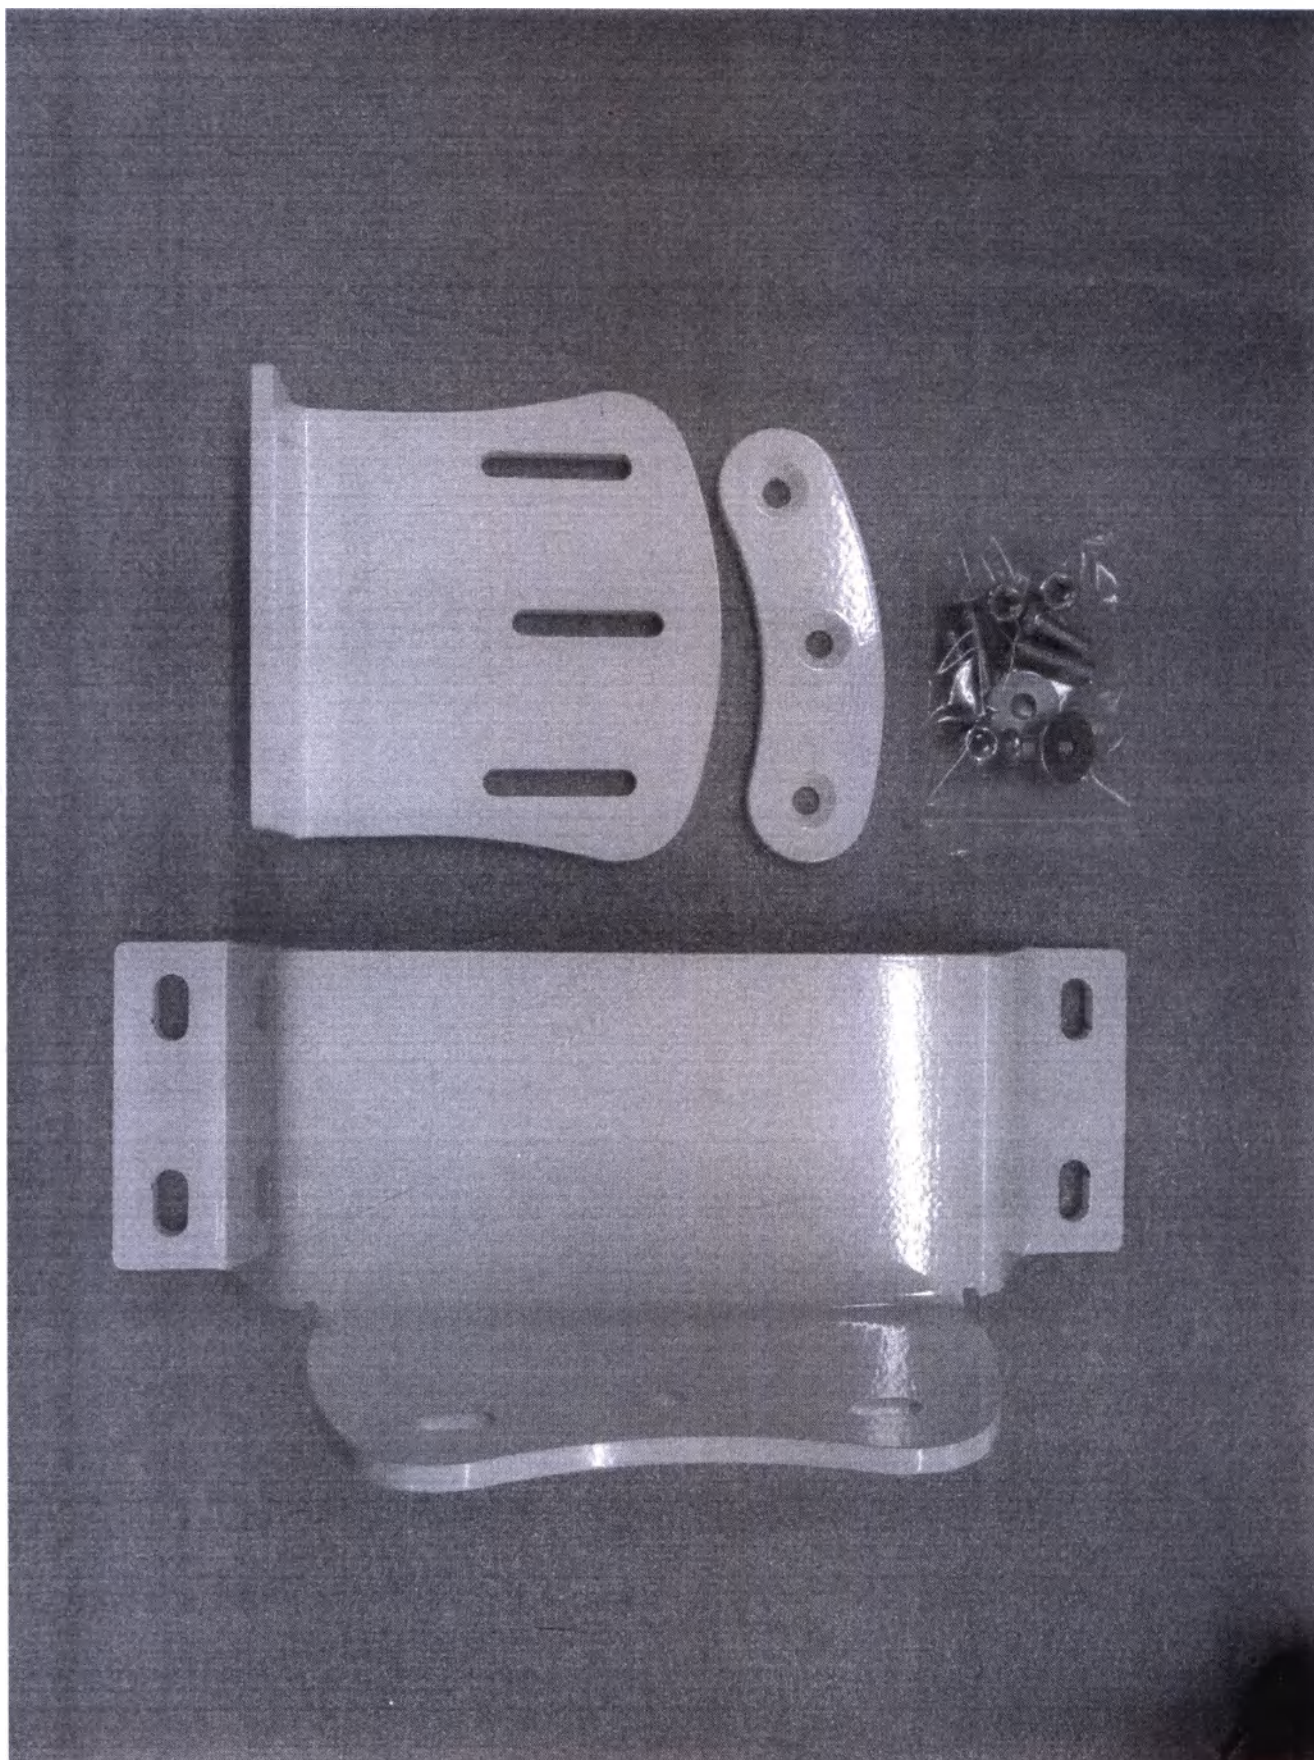

Нижний длинный и короткий настенные кронштейны

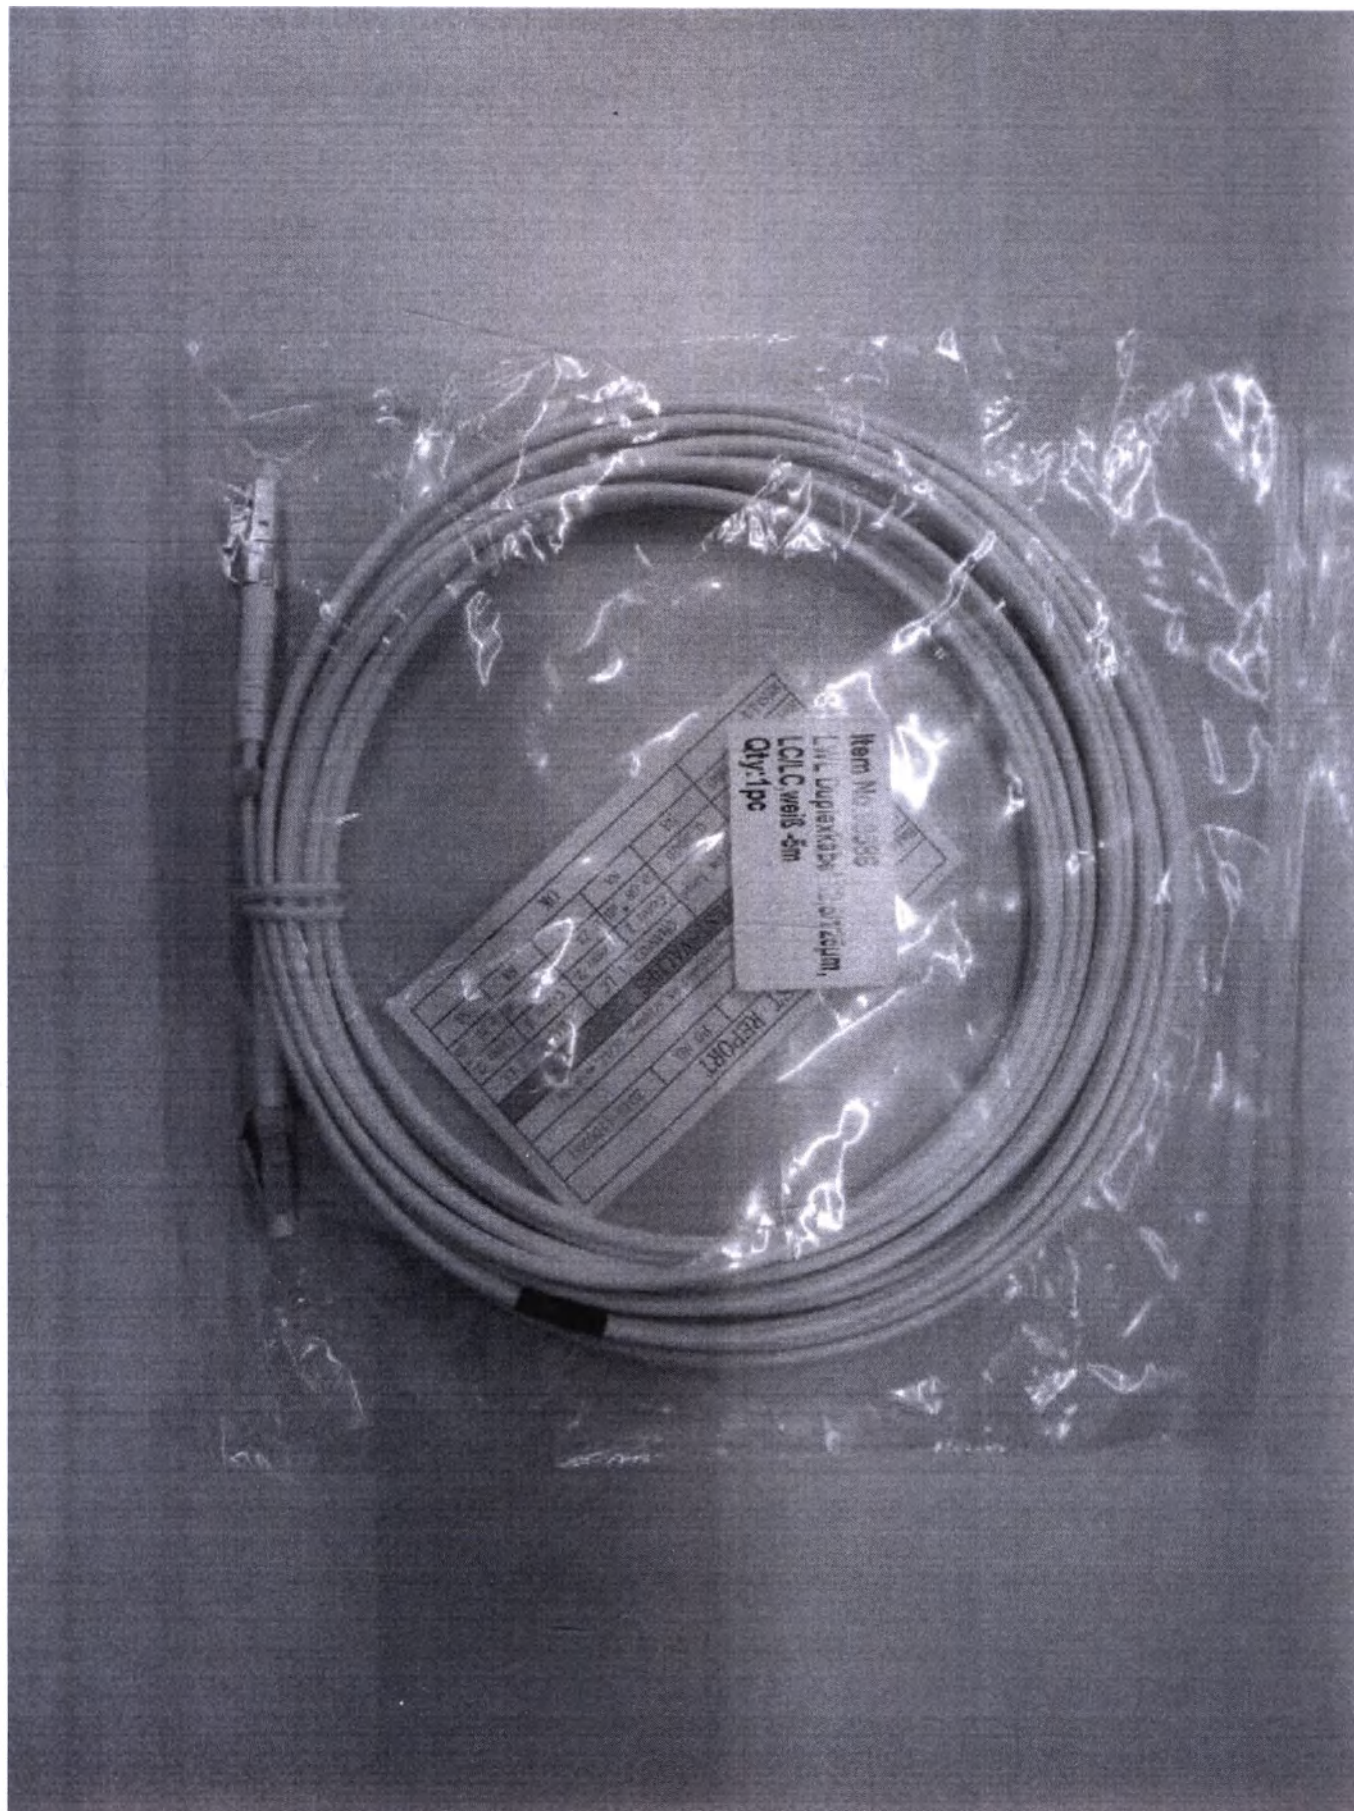


Оптический кабель 5 м



Оптический кабель 20 м



Набор калибровки и испытаний

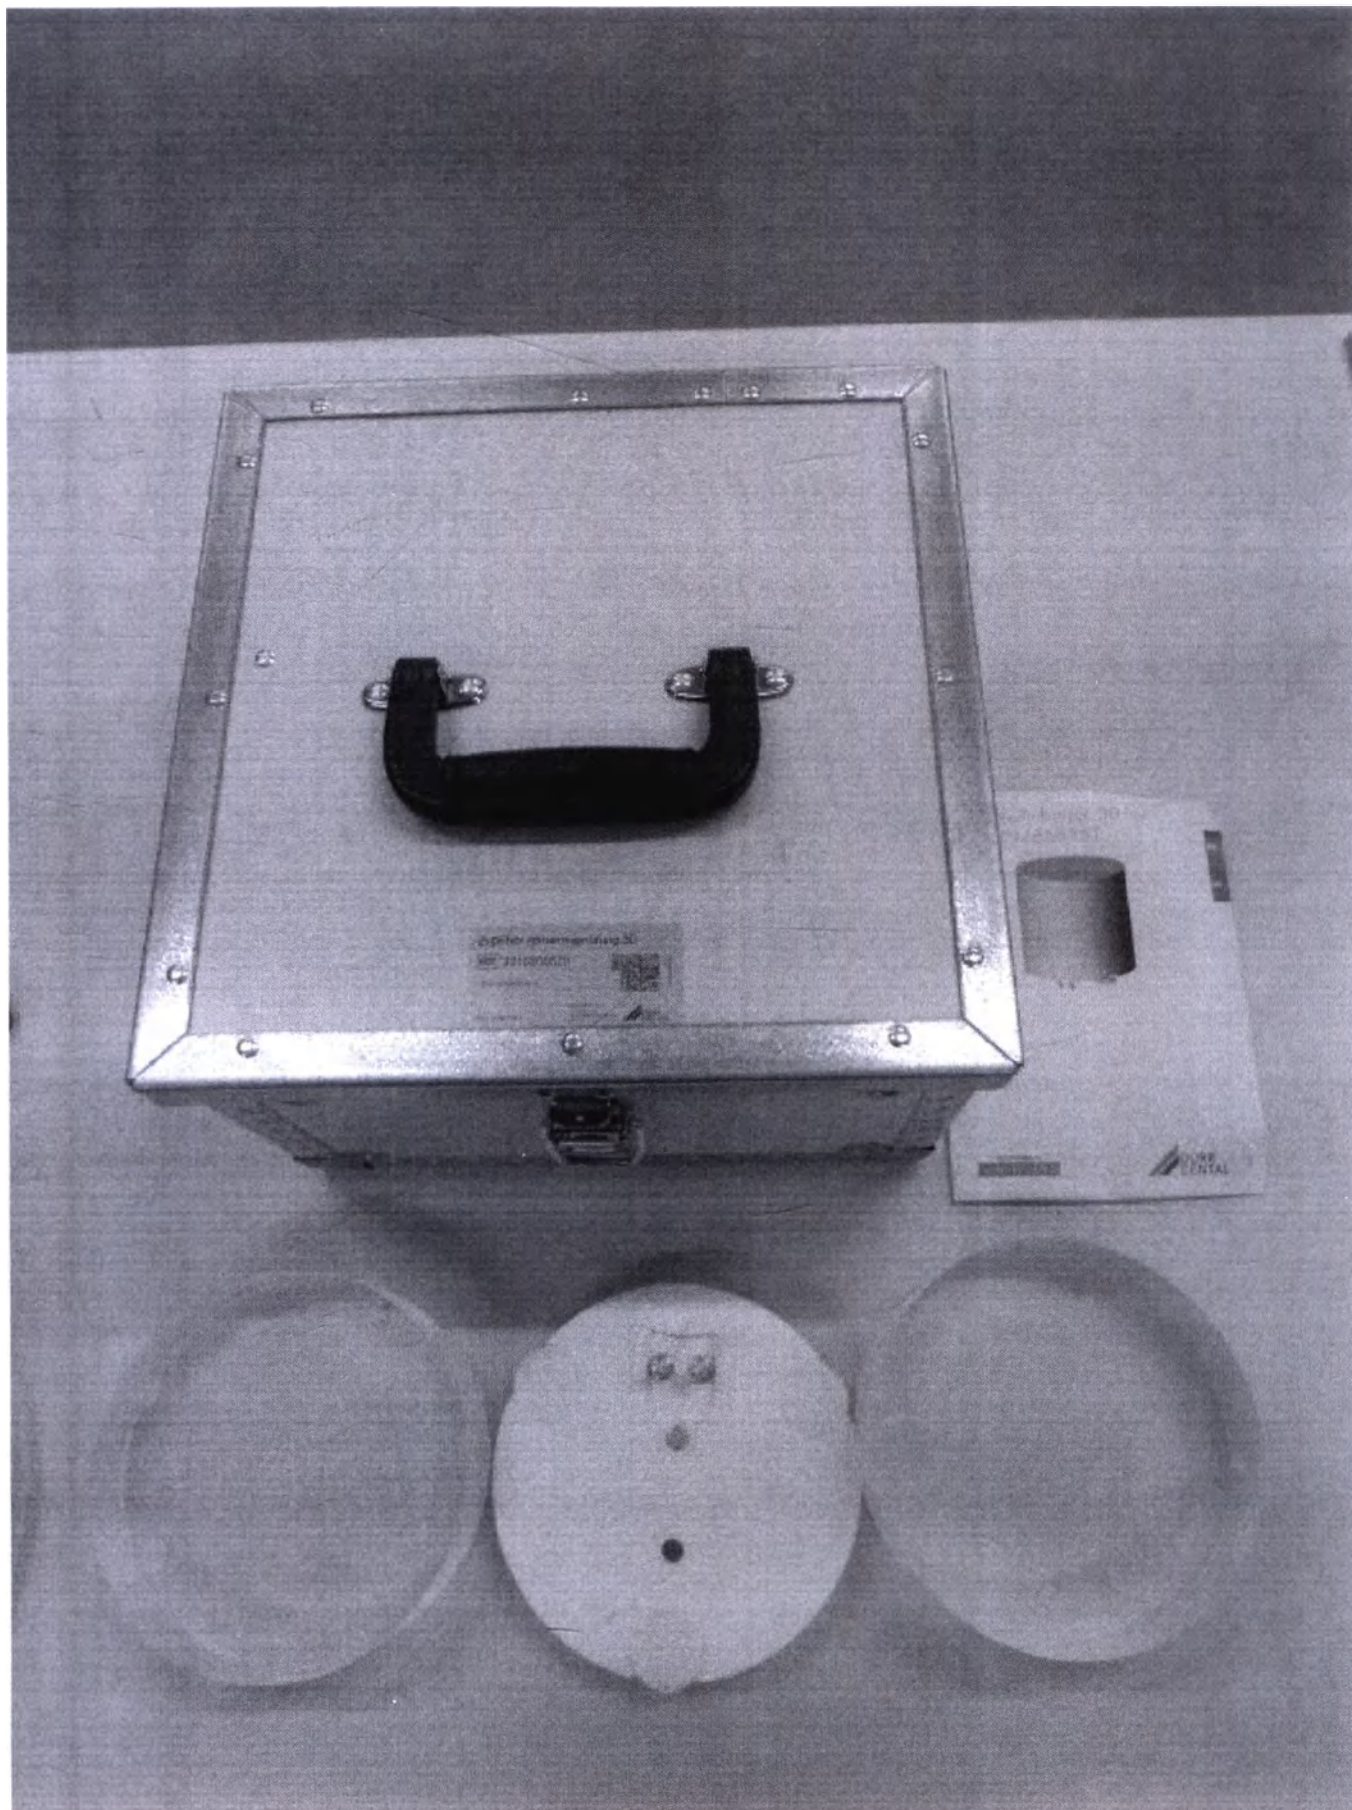

Тестирование приемочных испытаний 3D



Упаковка

ООО «Харико Дента Мед»
Итого в настоящем документе

31

листа (ов)

Генеральный директор
Бадгали Нараян Датт

