

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации





Горшкова Н.А.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C3 (Atellica CH C3))

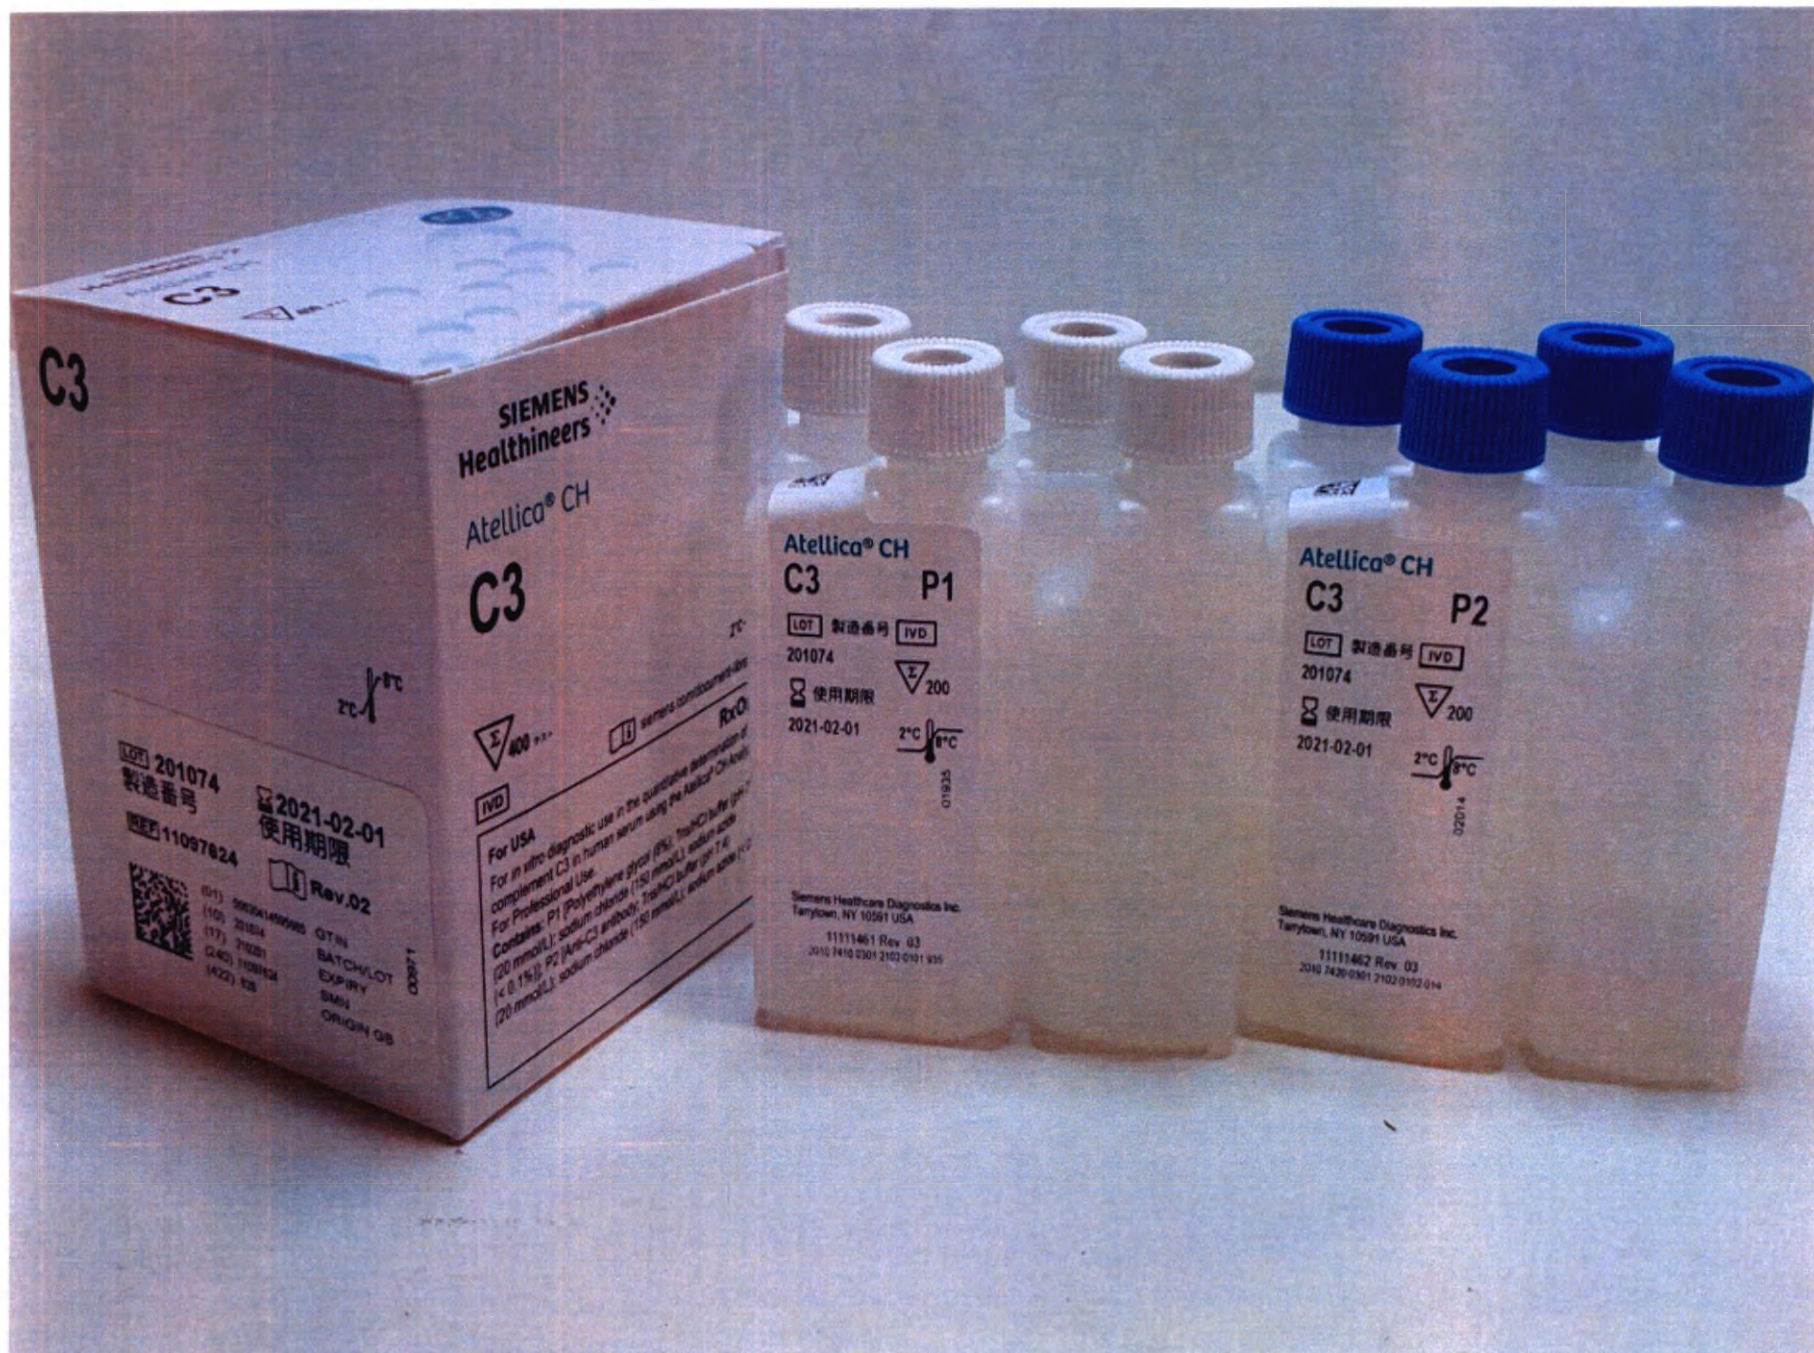

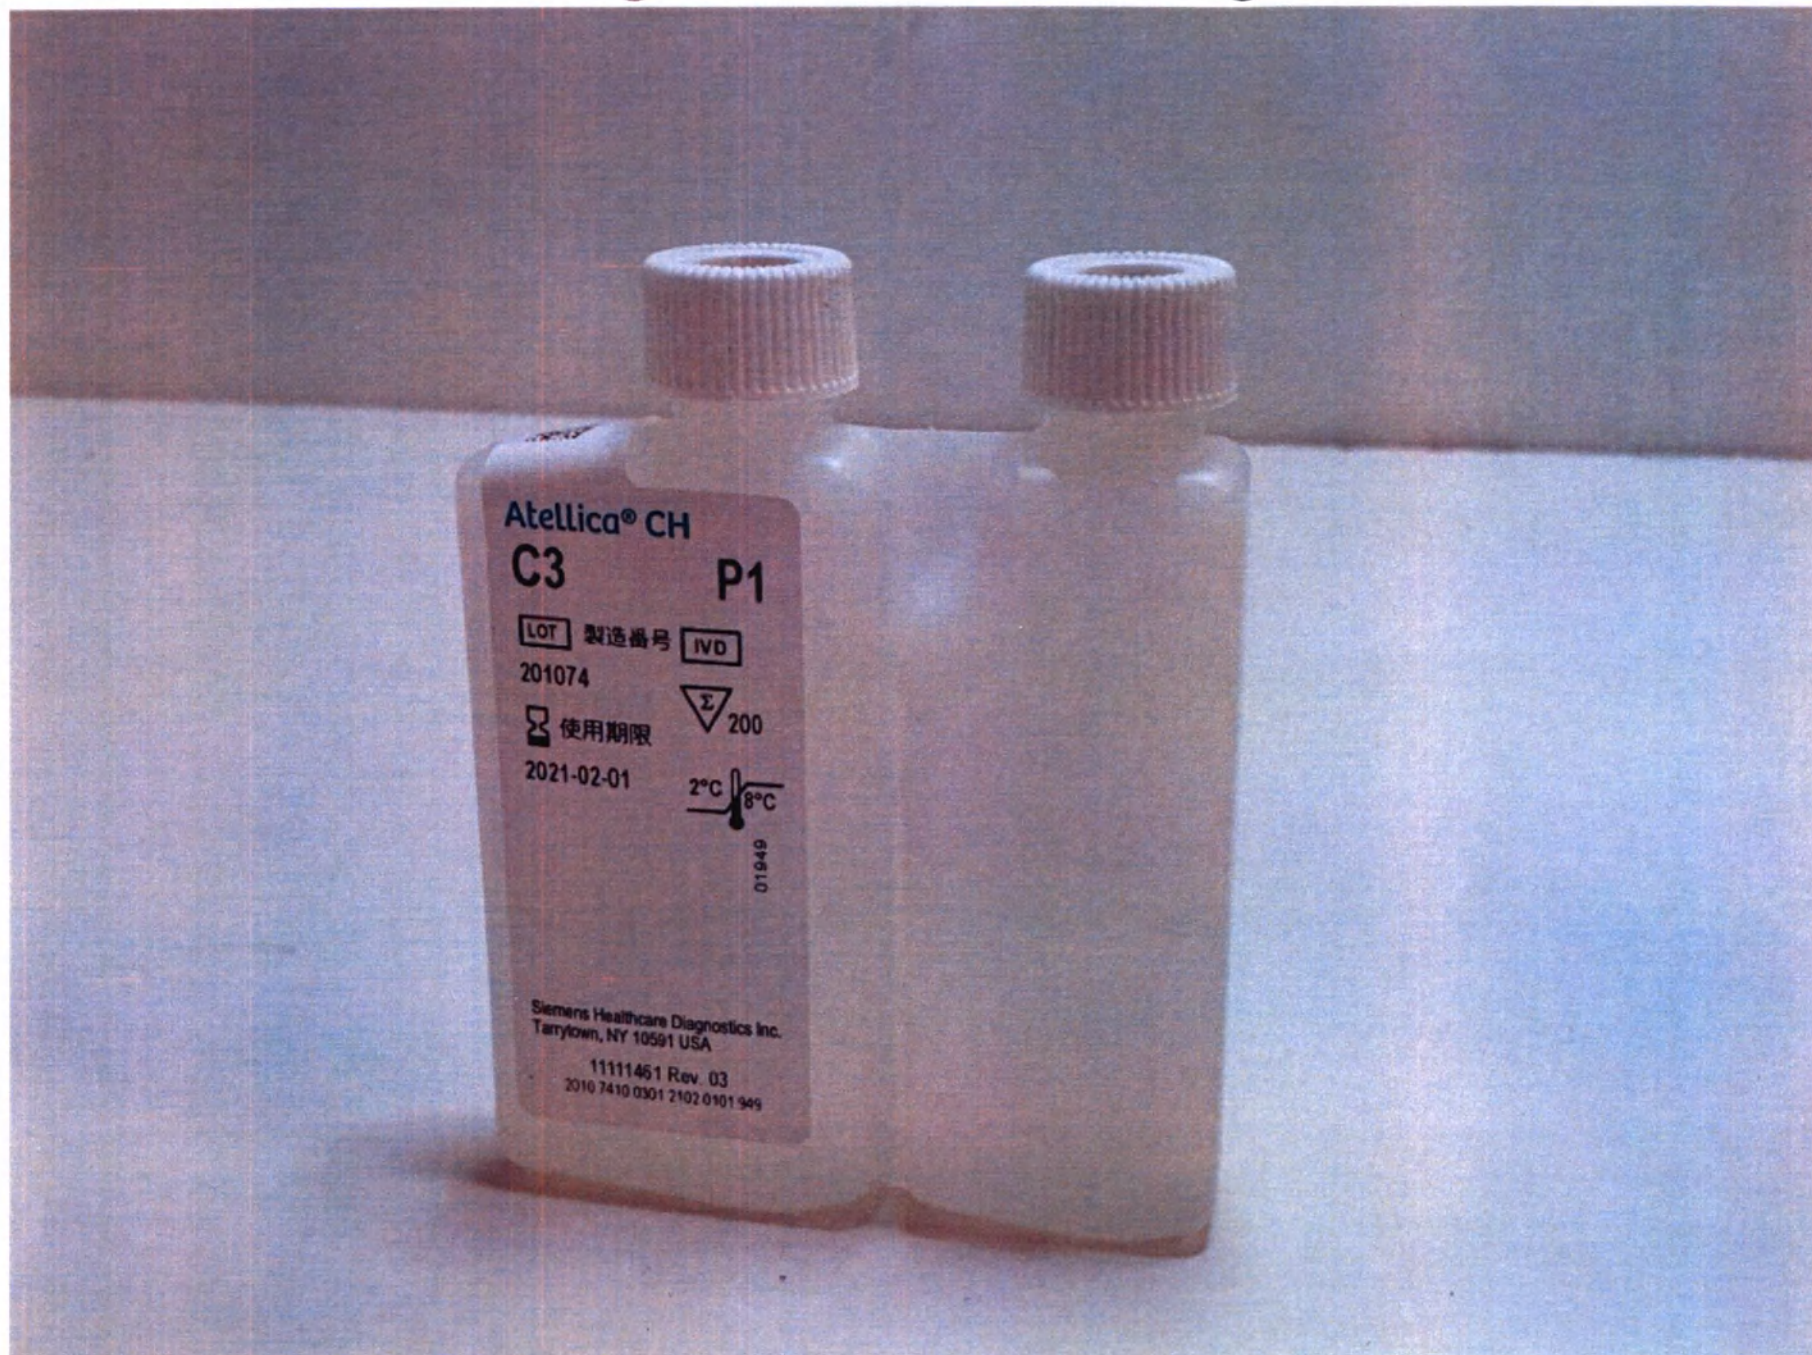

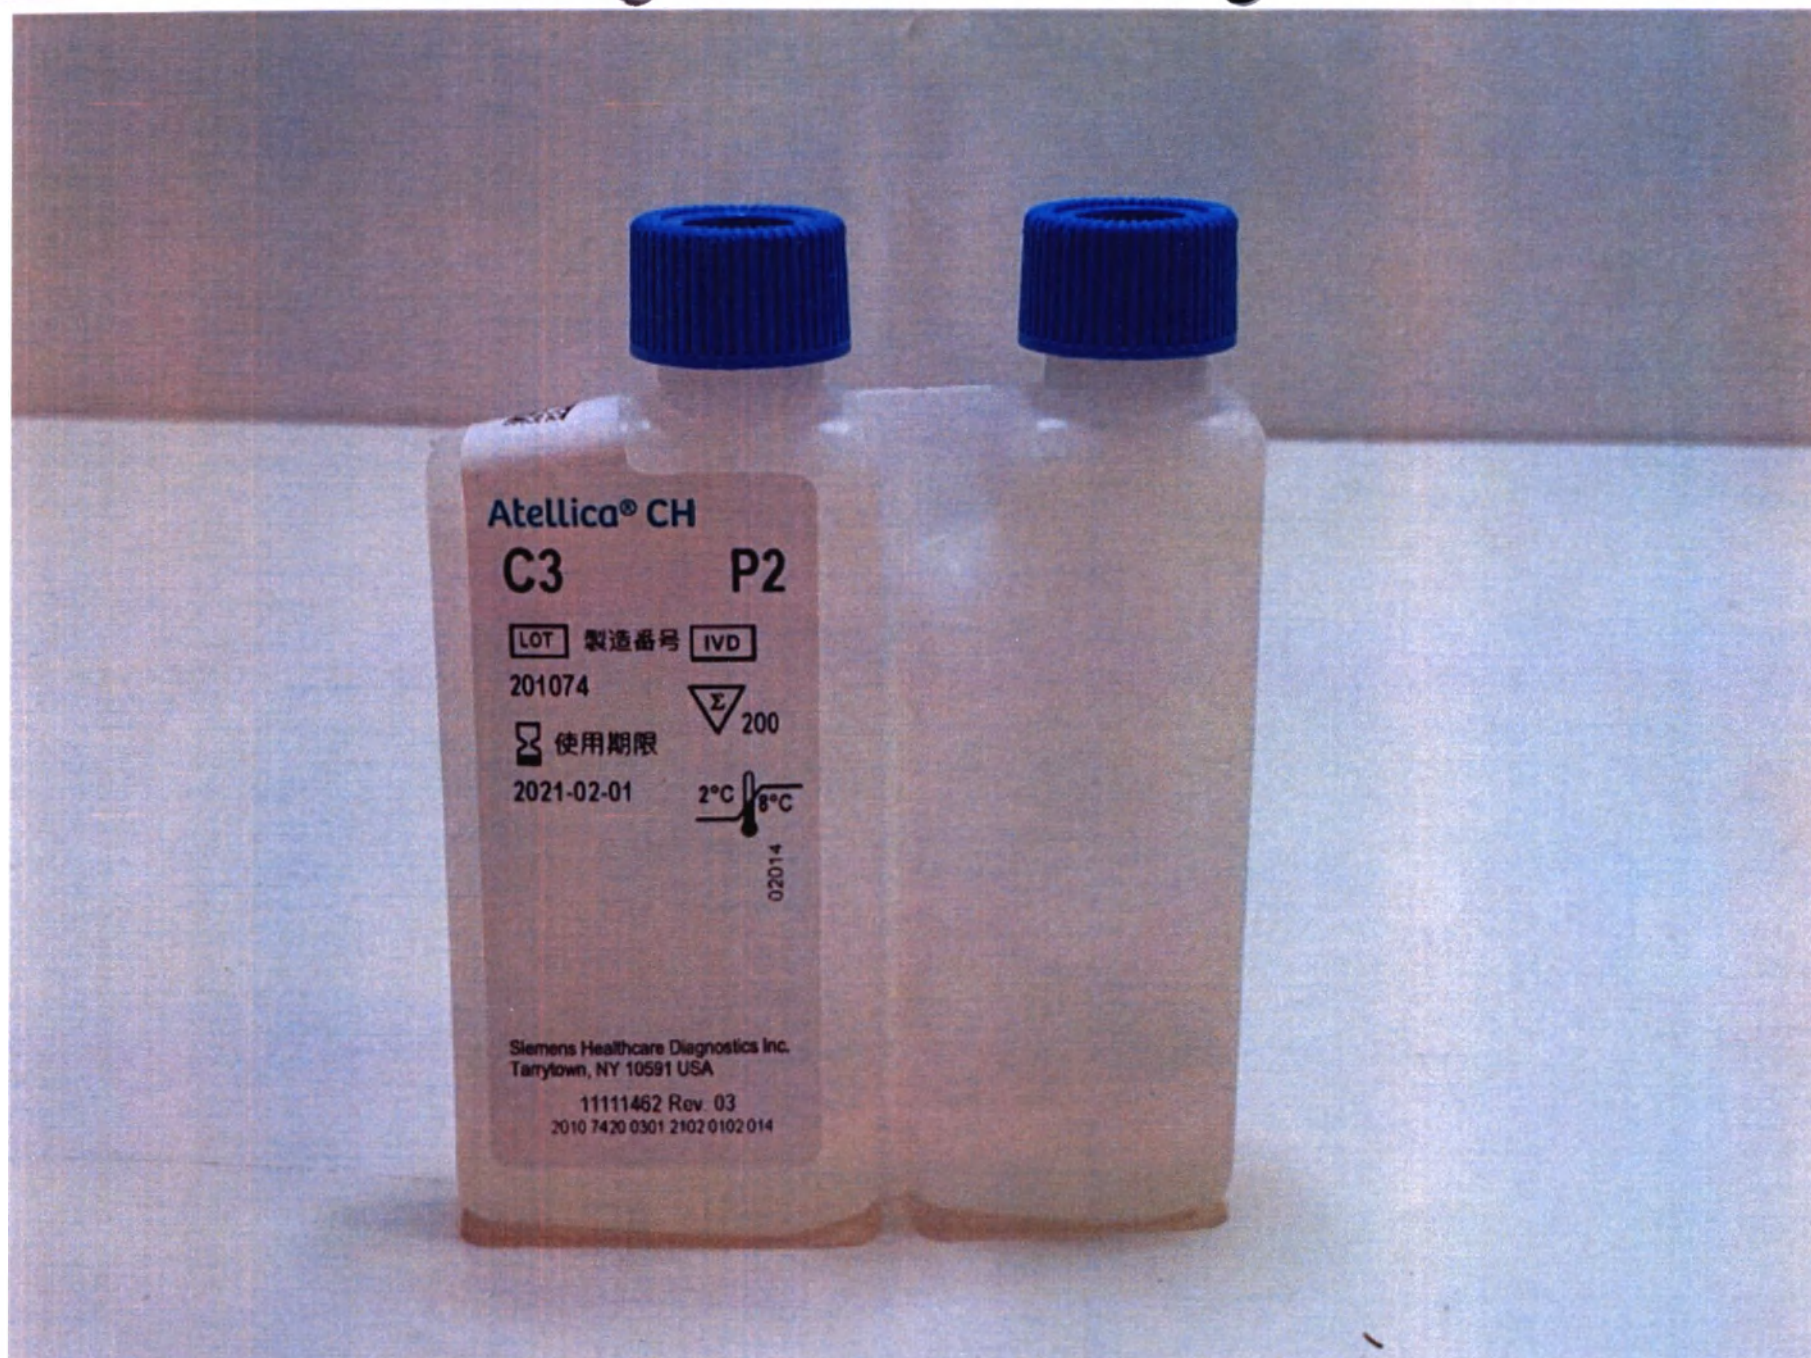


Рисунок 3 Набор реагентов для определения C3 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C3 (Atellica CH C3)):
Пакет 2 (Реагент 2, Atellica CH C3)



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

