



Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

Апрель 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur



Рисунок 1 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: упаковка изделия



Рисунок 2 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, общий вид изделия



Рисунок 3 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Основной реагент ADVIA Centaur TNIH ReadyPack

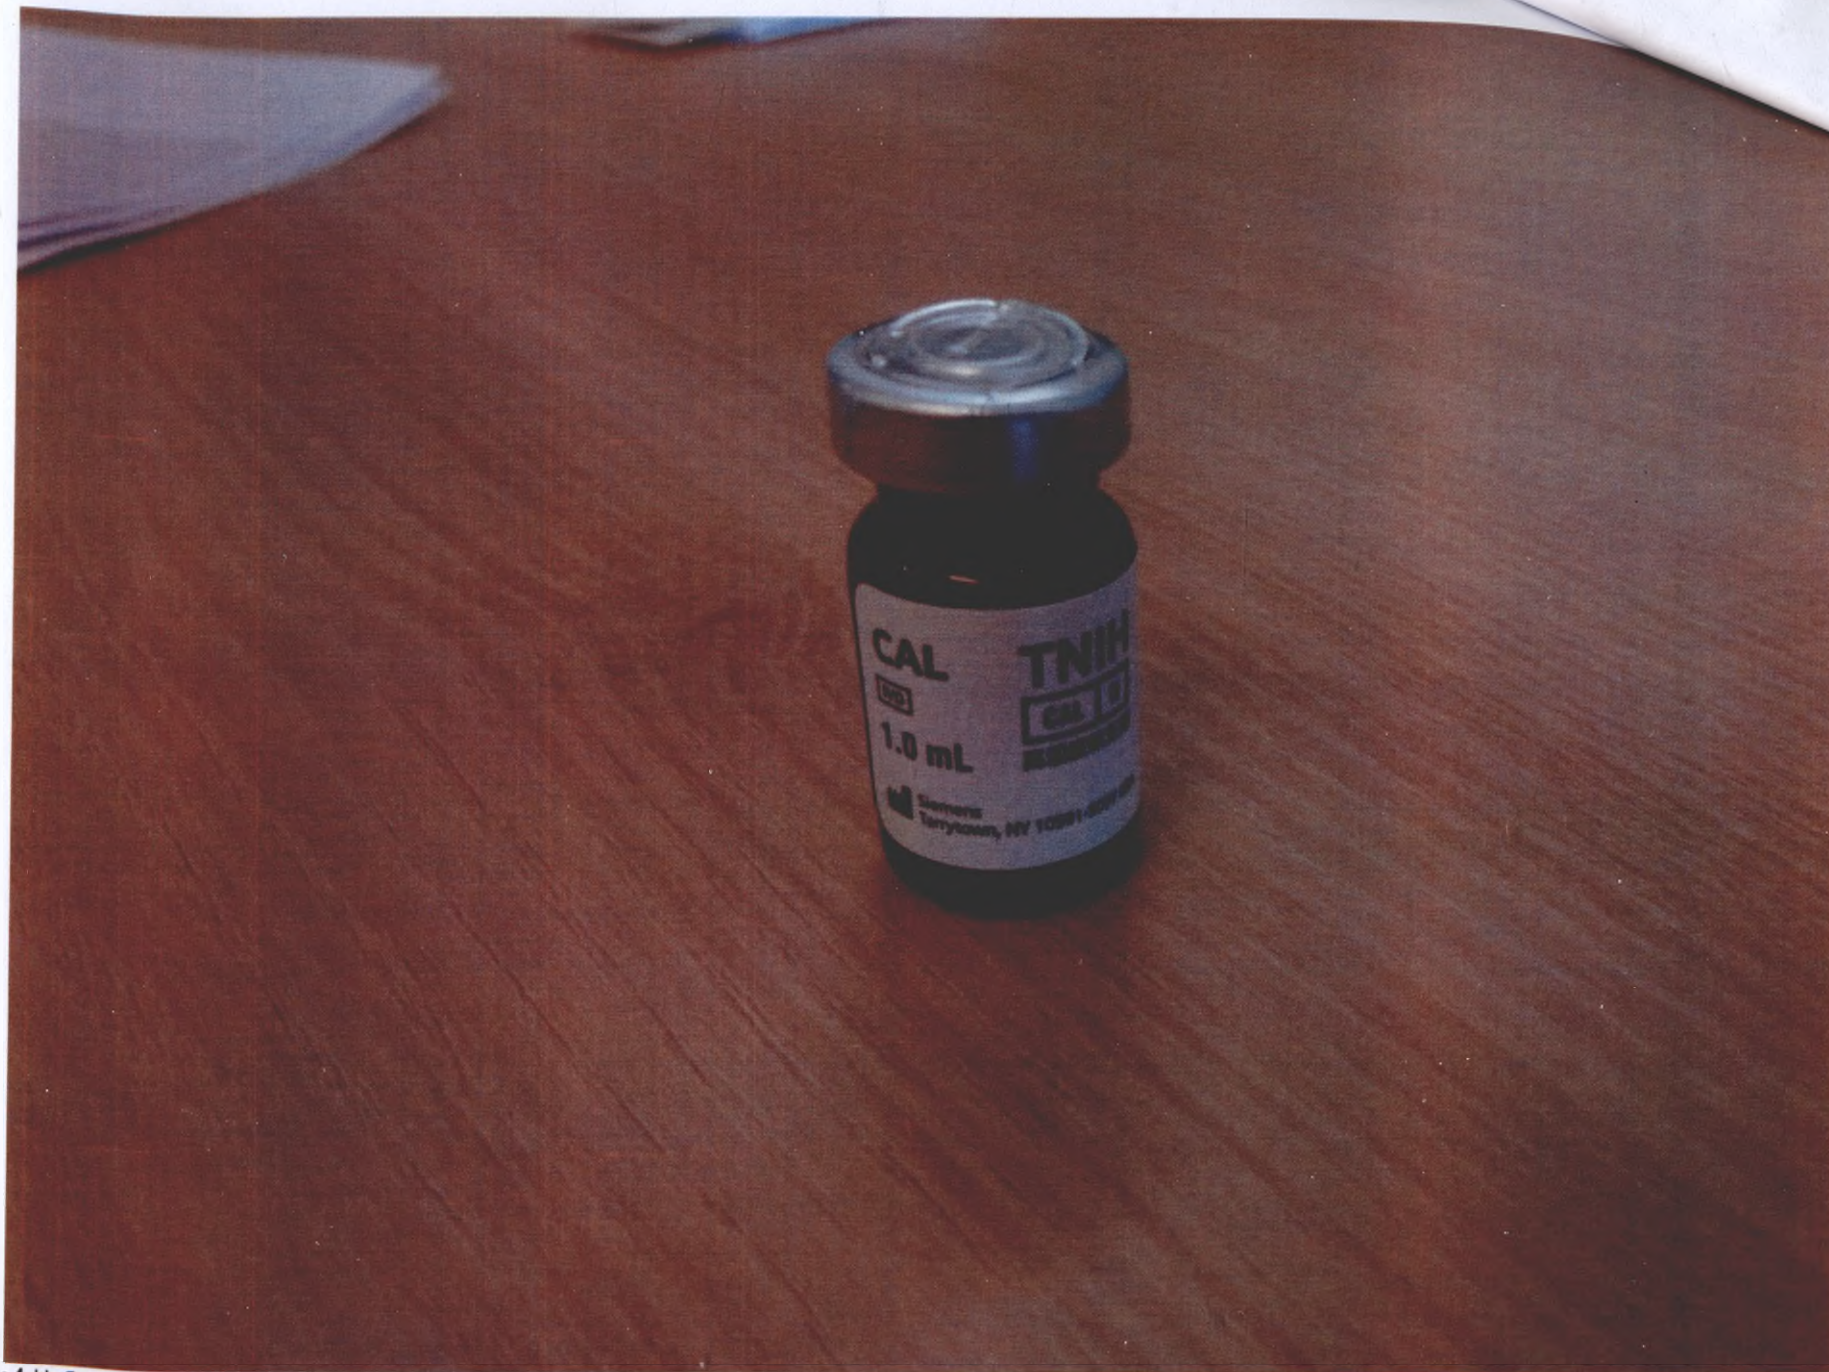


Рисунок 4 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Калибратор с высокой концентрацией ADVIA Centaur TNIH CAL H



Рисунок 5 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Калибратор с низкой концентрацией ADVIA Centaur TNIH CAL L



Рисунок 6 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для ADVIA Centaur TNIH

ADVIA Centaur®

TNIH

CAL

校正劑

Assigned Value Card

Carte des valeurs

Wertezuordnungskarte

Carta dei Valori Assegnati

Tarjeta de Valores Asignados

Cartão de Valores Definidos

Kort med tildelte værdier

Kort med angivna värden

表示値力ード

添付文書参照

01915795 Rev. B

LOT Ch.-B
製造番号

C4129

Exp./Verw. bis
使用期限

2020-07-16



c144c0fa

CAL



低濃度校正劑

CAL



高濃度校正劑

Mass/IUPAC: SI Units:

Mass/IUPAC: SI Units:

TNIH



0 PG/ML

0 NG/L

10000 PG/ML

10000 NG/L

Рисунок 7 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Карта значений и этикетки со штрих-кодами ADVIA Centaur TNIH Calibrator (Карта значений)



Рисунок 8 Набор реагентов для определения высокочувствительного тропонина I (ADVIA Centaur High-Sensitivity Troponin I (ADVIA Centaur TNIH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur, Карта значений и этикетки со штрих-кодами ADVIA Centaur TNIH Calibrator (Этикетки со штрих-кодами)

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

