

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов



_____ сентября 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ


**Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с иммуноингибированием,
без осаждения «HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ»,
ТУ 21.20.23-107-94568735-2021**

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.05

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РЗН 2021/15140 от 20.08.2021



LOT Серия: 0075



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml

R2: 1 x 15 ml

LOT 0075



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



2025.06

IVD

CE REP

EVERGO EUROPE
Prilassegracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық тежелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 1 x 45 мл

Реагент №2: 1 x 15 мл

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-ая, литера А



13052308000075

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.05
REF В 13.15

45 мл

2°C 8°C

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

CE



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.05
REF В 13.15

15 мл

2°C 8°C

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

CE



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.15

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 15 мл

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

LOT Серия: 0075



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml

R2: 2 x 15 ml

LOT 0075



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A 194356
St. Petersburg Russia

2025.06

IVD

ECIREP

EVERSO EUROPE
Priseesedgericht 20. 25/4 AP
The Hague The Netherlands

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерин концентрациясын бойынша шөгіндісіз, иммундық төжелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 45 мл

Реагент №2 : 2 x 15 мл

Сериялы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

тех in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АО Россия,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литера А



13152306000075

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.05 REF В 13.15

РЕАГЕНТ 1

45 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тех in vitro диагностикасы үшін

CE Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.05 REF В 13.15

РЕАГЕНТ 1

45 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тех in vitro диагностикасы үшін

CE Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.05 REF В 13.15

РЕАГЕНТ 2

15 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тех in vitro диагностикасы үшін

CE Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.05 REF В 13.15

РЕАГЕНТ 2

15 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тех in vitro диагностикасы үшін

CE Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.85

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0075
Дата выпуска: 2023.06
Годен до: 2025.06
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml
R2: 1 x 15 ml
Calibrator: 1 vial
IVD 2025.06

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, иммундық төжелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы
Реагент №1 : 1 x 45 мл
Реагент №2 : 1 x 15 мл
Калибратор: 1 құты

Сериялы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ -1,2 және гепатит С және HBsAg вируссына антиденелер жоқ тек in vitro диагностикасы үшін



13852308100075

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.85
REF B 13.95

45 мл
LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностика үшін



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.85
REF B 13.95

15 мл
LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностика үшін



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,45 ммоль/л (56,0 мг/дл)
лиофилизат

растворить в 3,0 мл дистиллированной воды
3,0 мл дистиллированнан сууда ертту керек

LOT 1023

Годен до: 2025.07
Дейін жарамды: 2025.07

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностика үшін



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.95

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06
только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 мл
R2: 2 x 15 мл
Calibrator: 1 vial
IVD 2025.06

K2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140
Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, иммундық төжелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы
Реагент №1 : 2 x 45 мл
Реагент №2 : 2 x 15 мл
Калибратор: 1 құты
Сериясы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ
только для in vitro диагностики
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АО Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



13952306100075

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.85
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 1
45 мл
LOT 0075
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.85
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 1
45 мл
LOT 0075
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.85
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 2
15 мл
LOT 0075
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.85
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 2
15 мл
LOT 0075
Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
Vital Development

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
1.45 ммоль/л (56.0 мг/дл)
лиофилизат
КАЛИБРАТОР
1.45 ммоль/л (56.0 мг/дл)
лиофилизат
растворить в 3.0 мл дистиллированной воды
3.0 мл дистиллированной воды
LOT 1023
Годен до: 2025.07
Дейн жарамды: 2025.07
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики
Vital Development

REF B 13.75-1.150

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

Calibrator: 1 vial

IVD 2025.06

Vital Development Corporation
Dorogaya v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық тежелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBATG вирусына антиденелер жоқ

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й лит. А



80042207210070

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.150

РЕАГЕНТ 2 14,5 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.150

РЕАГЕНТ 2 14,5 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.150

РЕАГЕНТ 1 40 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,45 ммоль/л (56,0 мг/дл) лиофилизат

Ресурсы: в 3,0 мл дистиллированной воды

3,0 мл дистиллированной воды

LOT 1023

Годен до: 2025.07

Дейн жарамды: 2025.07

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



REF B 13.705-1.150

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом, с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

ТУ 21.20.23-107-04568735-2021

РЭН 2021/15140 от 20.09.2021

LOT

Серия: 0075



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кашинку,
дом 55, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

LOT

0075

IVD

2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kashinku 55 A - 194356
St. Petersburg, Russia

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-04568735-2021

20.09.2021 г. РЭН 2021/15140

қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісі, иммундық тұрақтымен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 40 мл

Реагент №2 : 2 x 14,5 мл

Сериясы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

только in vitro диагностика үшін



80042104160062



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.705-1.150

РЕАГЕНТ 2

14,5 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

tex in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
Витал Девелопмент
Корпорейшн АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.705-1.150

РЕАГЕНТ 2

14,5 мл



LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

tex in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
Витал Девелопмент
Корпорейшн АҚ, Ресей

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.705-1.150

40 МЛ

LOT 0075



Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

tex in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорейшн АҚ, Ресей

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.705-1.150

40 МЛ

LOT 0075



Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

tex in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
Витал Девелопмент Корпорейшн АҚ, Ресей

REF B 13.75-1.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуоингибированием, без осаждения

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 7 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0075



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 мл

R2: 4 x 7 мл

Calibrator: 1 vial

LOT 0075



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.06

K2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық тежелумен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 7 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

83002306100075

HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06


Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0075

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей




REF В 13.705-1.200

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения



Реагент №1: 4 x 20 мл

ТУ 21.20.23-107-04508736-2021

Реагент №2: 4 x 7 мл

РЭН 2021/16140 от 20.08.2021

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL 1

LOT

Серия: 0076

Дата выпуска: 2023.06

Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемперу,
дом 68, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 7 ml

LOT 0076

Vital Development Corporation
Doroga v Kemperu, 68 A "9429
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.06

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-04508736-2021
20.08.2021 г. РЭН 2021/16140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісі, иммундық төкелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 20 мл

Реагент №2 : 4 x 7 мл

Сериясы: 0076
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

"Витал Девелопмент Корпорейшн", АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемперу,
дом 68, литера А

только для in vitro диагностики



1



80032104140077

HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0076

годен до: 2025.06

Действителен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей

REF B 13.75-1.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуоингибированием, без осаждения

Реагент №1: 3 x 50 мл

Реагент №2: 3 x 18 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0075 Дата выпуска: 2023.06 Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml

R2: 3 x 18 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0075

IVD 2025.06

Vita Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194358
St. Petersburg, Russia

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық төжелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

Реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 50 мл

Реагент №2 : 3 x 18 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0075
Шығарылған күні: 2023.06
Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ
тек in vitro диагностикасы үшін



81032308100075



HDL 1

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1.45 ммоль/л (56.0 мг/дл)
лиофилизат

Растворить в 3.0 мл дистиллированной воды
3.0 мл дистиллированной воды

LOT 1023

Годен до: 2025.07
Дейн жарамды: 2025.07

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF В 13.705-1.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 3 x 50 мл

Реагент №2: 3 x 18 мл

ТУ 21.20.23-107-94566735-2021

РЭН 2021/16140 от 20.06.2021

LOT

Серия:

0075



Дата выпуска:

2023.06



Годен до:

2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпту,
дом 58, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml

R2: 3 x 18 ml

LOT

0075



2023.06

MD

K2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94566735-2021
20.06.2021 г. РЭН 2021/16140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша методісіміз, иммундық техникамен миниматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 50 мл

Реагент №2 : 3 x 18 мл

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпту,
дом 58, литера А



80042104160062

HDL

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 1

50 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 2

18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 2

18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.300

РЕАГЕНТ 2

18 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Ресей

REF B 13.75-1.420

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 64 мл

Реагент №2: 2 x 23 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0075

Дата выпуска: 2023.06

Годен до: 2025.06

Годен до: 2025.06

для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml

R2: 2 x 23 ml

Calibrator: 1 vial

IVD

2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.08.2021 ж. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, иммундық тежелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 64 мл

Реагент №2: 2 x 23 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



82042306100075



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.420

23 мл

2°C 8°C

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент

Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент

Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.420

23 мл

2°C 8°C

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент

Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент

Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.420

1 64 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-1.420

1 64 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

1,45 ммоль/л (56,0 мг/дл)

лиофилизат

растворить в 3,0 мл дистиллированной воды

3,0 мл дистиллированной воды

LOT 1023

Годен до: 2025.07

Дейін жарамды: 2025.07

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 13.705-1.420

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 64 мл

Реагент №2: 2 x 23 мл

ТУ 21.20.23-107-84868735-2021

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

LOT

Серия:

0075



Дата выпуска:

2023.06



Годен до:

2025.06

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184386 Санкт-Петербург, Дорога в Кемпинг,
дом 55, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml

R2: 2 x 23 ml

LOT

0075

MD

2025.06

R2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-84868735-2021

20.08.2021 г. РЗН 2021/15140

Қан сывороткасында (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық техникамен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 64 мл

Реагент №2: 2 x 23 мл

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

только in vitro диагностики үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн", АО, Россия,
184386, Санкт-Петербург, Дорога в Кемпинг, дом 55, литера А



80042104160062

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.420

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.420

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.420

23 мл

РЕАГЕНТ 2

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.705-1.420

23 мл

РЕАГЕНТ 2

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
только in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО, Россия

REF В 13.75-2.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

ТУ 21.20.23-107-94588736-2021

РЗН 2021/15140 от 20.08.2021

LOT

Серия: 0075

Дата выпуска: 2025.06

Годен до: 2025.06

Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184385 Санкт-Петербург, Дорога в Кеману,
дом 55, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 40 ml

R2: 1 x 14 ml

LOT 0075

IVD

2025.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kemanu, 55 A 184385
St. Petersburg, Russia

K2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94588736-2021

20.08.2021 г. РЗН 2021/15140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, иммундық тежелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 1 x 40 мл

Реагент №2 : 1 x 14 мл

Сериясы: 0075

Шығарылған күні: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только in vitro диагностическим

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
184385 Санкт-Петербург, Дорога в Кеману,
дом 55, литера А



84042104180092



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
так in vitro диагностическим

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.200

РЕАГЕНТ 2

14 мл

LOT 0075

Годен до: 2025.06

Дейин жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
так in vitro диагностическим

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АО Россия

REF В 13.715-2.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 3 x 16 мл

Реагент №2: 1 x 16 мл

ТУ 21.20.23-107-84568735-2021

РЭН 2021/18140 от 20.08.2021

LOT Серия: 0078

Дата выпуска: 2023.06

Годен до: 2025.06

только для in vitro диагностики

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 16 ml

R2: 1 x 16 ml

LOT 0078

MD

2025.06

Vital Development Corporation
Dorogoye Kaleninskoye St. 14-15
St. Petersburg, Russia

KZ HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-84568735-2021

20.08.2021 ж. РЭН 2021/18140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша анықтаса, иммундық тежелуімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1: 3 x 16 мл

Реагент №2: 1 x 16 мл

Сериясы: 0078

Шығарылған күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development Corporation




80042104180082

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.715-2.200

16 мл



LOT 0078

Годен до: 2025.06


Дейн жарамды: 2025.06

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АК, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.715-2.200

16 мл



LOT 0078

Годен до: 2025.06


Дейн жарамды: 2025.06

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АК, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.715-2.200

16 мл



LOT 0078

Годен до: 2025.06


Дейн жарамды: 2025.06

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АК, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.715-2.200

16 мл



LOT 0078

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АК, Россия

REF В 13.75-2.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 4 x 45 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 30 мл

РЭН 2021/16140 от 20.06.2021



Серия: 0076



Дата выпуска: 2023.06



Годен до: 2026.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дачная в Каньон-у,
дом 65, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 45 мл

R2: 2 x 30 мл



0076

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
Санкт-Петербург, Дачная в Каньон-у,
дом 65, литера А

2025.06

K2 HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
20.06.2021 г. РЭН 2021/16140

Қан сарысуындағы (плазмадағы) жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісі, иммундық тәсілімен энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 45 мл

Сериясы: 0076

Реагент №2: 2 x 30 мл

Иммунитетті күні: 2023.06

Дейін жарамды: 2025.06

только in vitro диагностика үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн", АО, Россия
194366 Санкт-Петербург, Дачная в Каньон-у, дом 65, литера А

63032104160062



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 2 30 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 2 30 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.75-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT: 0076

Годен до: 2025.06

Дейн жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

16 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
_____ А.Г.Плехов



_____ 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения «HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ [REF] B 13.05

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения



Реагент №1 1 x 45 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

Реагент №2: 1 x 15 мл

РУ

LOT Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml

LOT 0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R2: 1 x 15 ml

2022.01

IVD

EC/REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



13052104000062



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ [REF] B 13.15

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВН) в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без охлаждения

Реагент №1 2 x 45 мл
Реагент №2 2 x 15 мл

ТУ 21 20 23-107-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194366 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml
R2: 2 x 15 ml

LOT 0011

2022.01

Vital Development Corporation
Doroga - Kamenuk St A 194366
St. Petersburg, Russia

IVD

ECIREP

EMERGO EUROPE
Prosesssigrapt 20 2514-01
The Hague, The Netherlands



13162104000062

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.05
REF B 13.15
45 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
CE Vital

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.05
REF B 13.15
45 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
CE Vital

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.05
REF B 13.15
15 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
CE Vital

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.05
REF B 13.15
15 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
CE Vital

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.85

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml

R2: 1 x 15 ml

Calibrator: 1 vial

LOT

0011

IVD




2022.01

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuki 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



13852104160062

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.85
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 1
45 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики
Vital

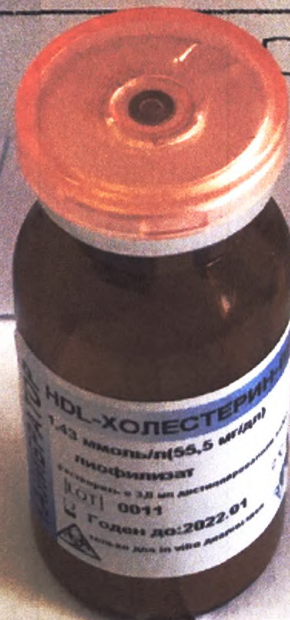

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
15 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.95

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 2 x 45 мл
Реагент №2 2 x 15 мл
Калибратор 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml

R2: 2 x 15 ml

Calibrator: 1 vial

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD




2022.01



13852104160062

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.95
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 1
45 мл
LOT 0011
Годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики
Vital

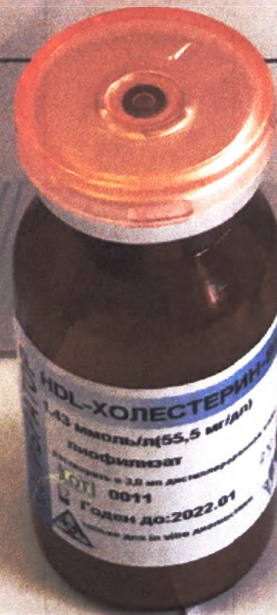

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF B 13.95
REF B 13.95
РЕАГЕНТ 2
15 мл
LOT 0011
Годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики

[REF] В 13.75-1.150

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим, колориметрическим методом 2 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 2 x 40 мл

Реагент №2 2 x 14,5 мл

Калибратор 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94565735-2021

ру

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

Calibrator: 1 vial

LOT

0011



2022.01



IVD



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



80042104160062

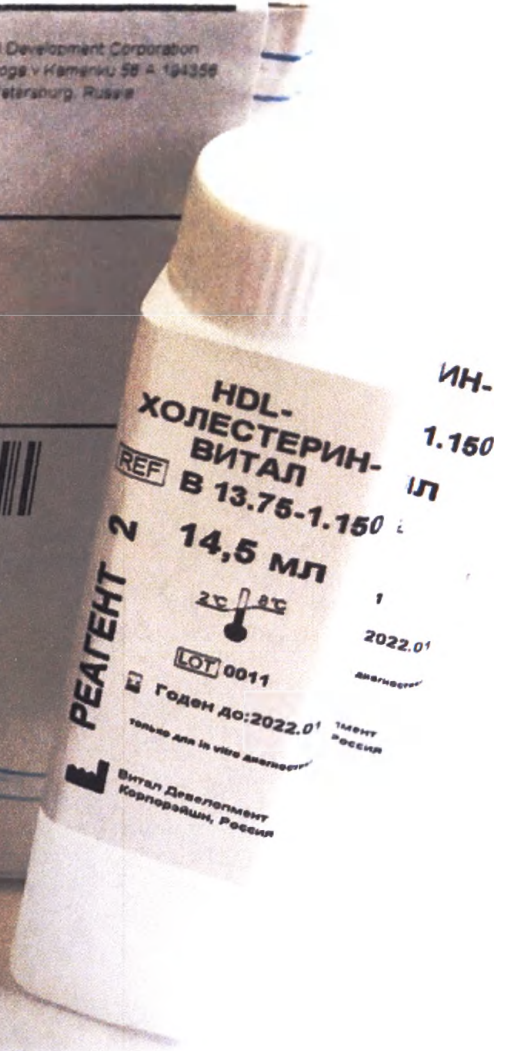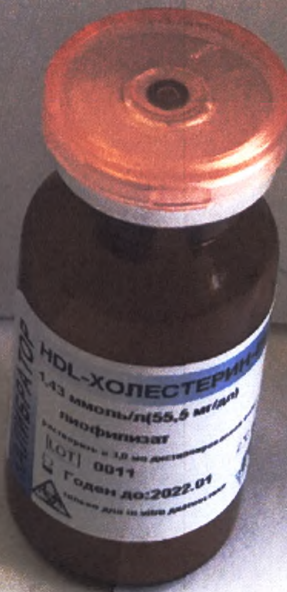

REF В 13.705-1.150

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

LOT

0011



2022.01

IVD



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia



80042104180082



ТЕСТЕРИН-ВИТАЛ

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.705-1.150
40 МЛ

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.705-1.150
14,5 МЛ

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

[REF] В 13.75-1.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 4 x 20 мл

Реагент №2 4 x 7 мл

Калибратор 1 флакон

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 7 ml

Calibrator: 1 vial

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194355
St. Petersburg, Russia




2022.01

IVD



80032104140077

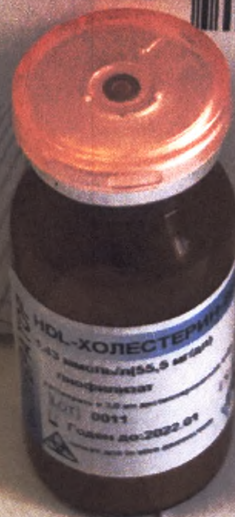

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1
20 МЛ
REF В 13.75-1.200
2°C 8°C

LOT

0011

годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

РЕАГЕНТ 2

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
7 МЛ
REF В 13.75-1.200
2°C 8°C

LOT

0011

годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 13.705-1.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с иммуоингибированием, без осаждения

Реагент №1: 4 x 20 мл
Реагент №2: 4 x 7 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.01



Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 ml
R2: 4 x 7 ml

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.01

IVD






80032104140077



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
20 МЛ
REF В 13.705-1.200
2°C 8°C
LOT 0011
годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
7 МЛ
REF В 13.705-1.200
2°C 8°C
LOT 0011
годен до: 2022.01
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

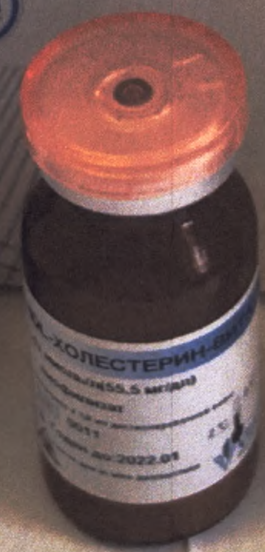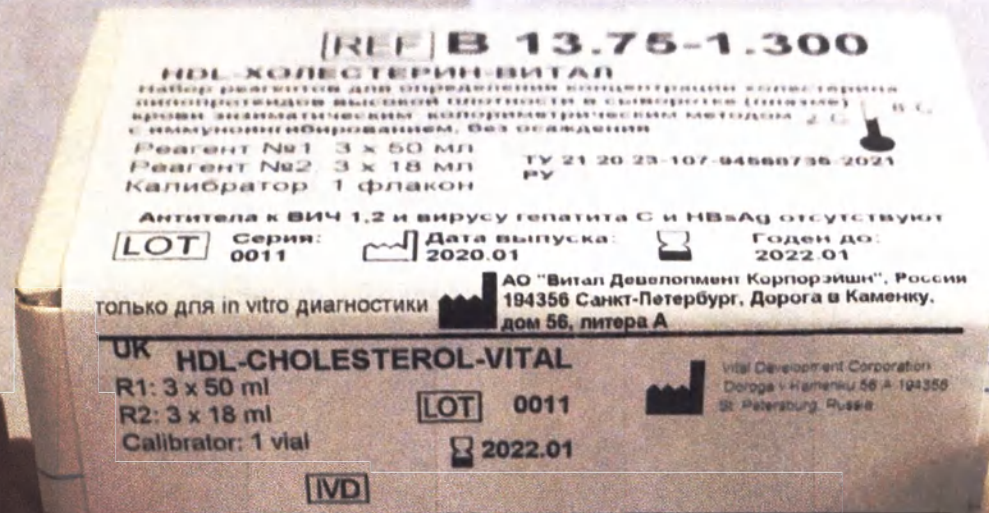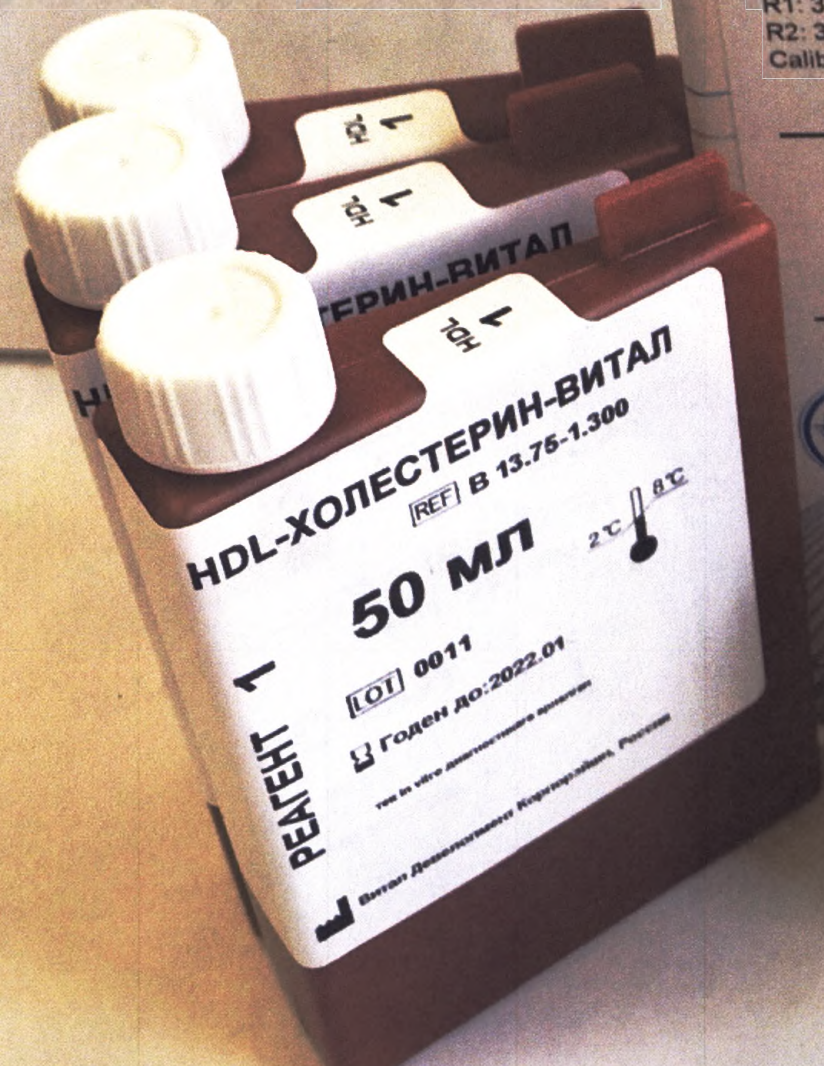

[REF] В 13.705-1.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C 8 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 3 x 50 мл
Реагент №2 3 x 18 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

[LOT]

Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.01



Годен до:
2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml

R2: 3 x 18 ml

[LOT]

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia








2022.01

[IVD]



80042104160062

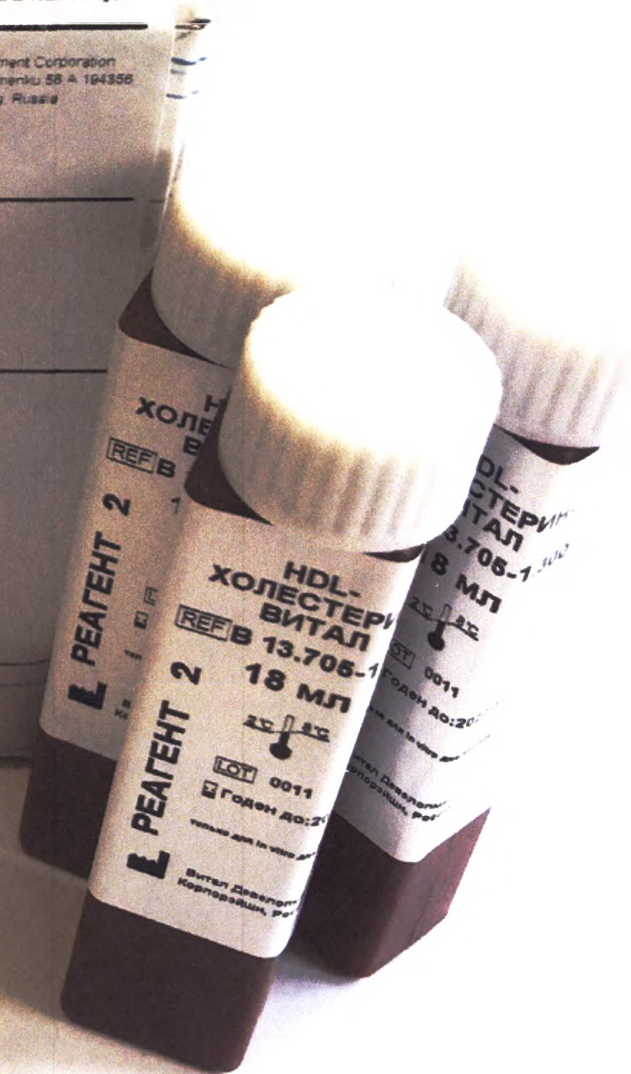

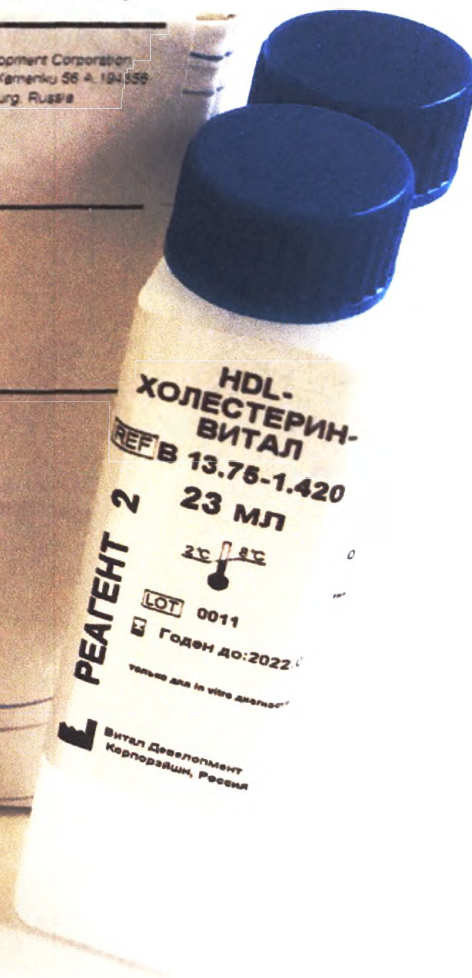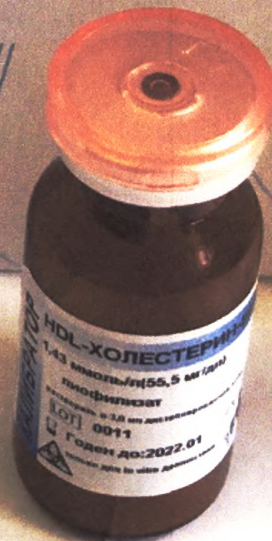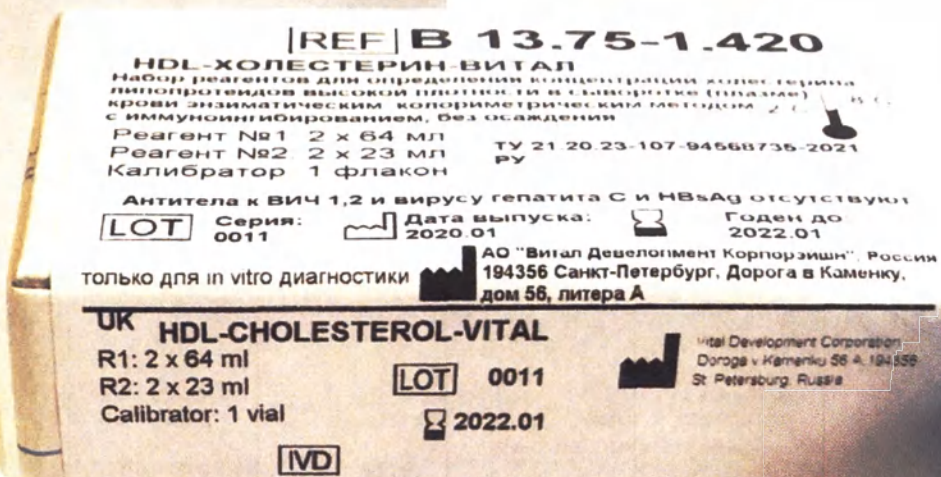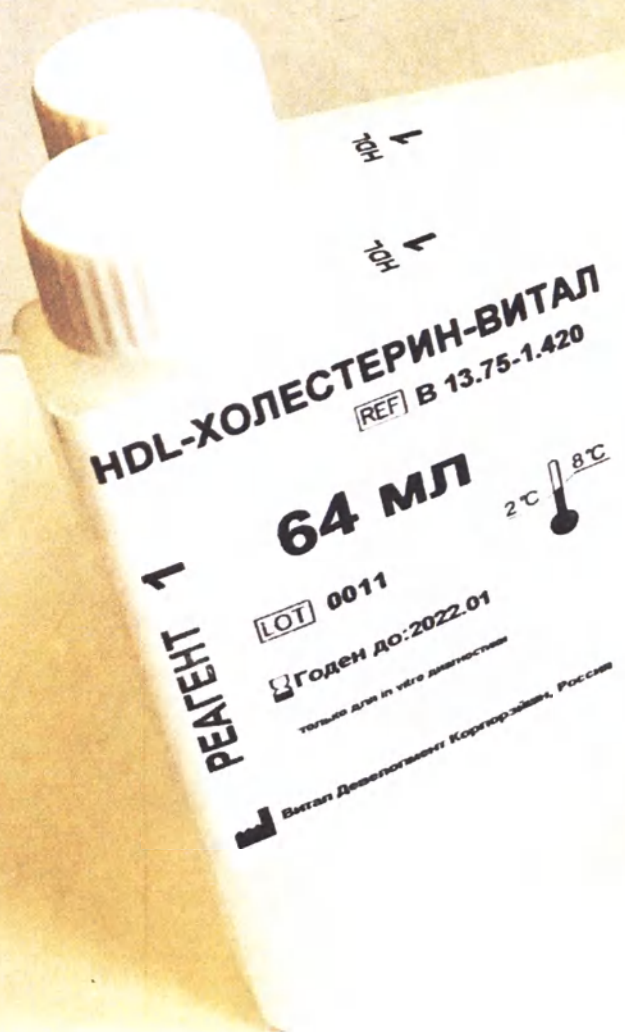

REF В 13.705-1.420

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C 8 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 2 x 64 мл ту 21 20 23-107-94568735-2021
Реагент №2 2 x 23 мл ру

LOT

Серия
0011



Дата выпуска
2020 01



Годен до
2022 01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" Россия
194156 Санкт-Петербург, Дворца в Кладбищу
дом 36, корпус А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml
R2: 2 x 23 ml

LOT

0011

2022.01

(MD)



60042104160082



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
(REF) В 13.705-1.420

64 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
(REF) В 13.705-1.420

РЕАГЕНТ 2 23 мл

LOT 0011

Годен до: 2022

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 13.75-2.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина
липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме)
крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C 8 C
с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 1 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.01



Годен до:
2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 40 ml

R2: 1 x 14 ml

LOT

0011



2022.01



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



80042104160082



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.75-2.200

40 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.01

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.75-2.200

14 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.01

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

[REF] В 13.715-2.200

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1: 3 x 16 мл
Реагент №2: 1 x 16 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.01



Годен до:
2022.01

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 16 ml
R2: 1 x 16 ml

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.01

IVD



80042104180062



HDL-
ХОЛЕСТЕРИН-
ВИТАЛ
В 13.715-2.200

16 мл



LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF B 13.75-2.300

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 C с иммуноингибированием, без осаждения

Реагент №1 4 x 45 мл

Реагент №2 2 x 30 мл

ТУ 21.20.23-107-94568735-2021

РУ

LOT

Серия:

0011



Дата выпуска:

2020.01



Годен до:

2022.01

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK HDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 45 ml

R2: 2 x 30 ml

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.01

IVD



80042104160062



HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-2.300

45 мл

2 C

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-2.300

45 мл

2 C

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

HDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.75-2.300

30 мл

2 C

LOT 0011

Годен до: 2022.01

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

16 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.