

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов
низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим
колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения
«LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-106-94568735-2021**

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.06

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
 Реагент №2: 1 x 15 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
 РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT Серия: 0094
 Дата выпуска: 2023.05
 Годен до: 2025.05
 только для in vitro диагностики

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL
 R1: 1 x 45 ml
 R2: 1 x 15 ml
 LOT 0094
 2025.05
 IVD
 EC REP
 AO "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А
 Vital Development Corporation
 Dorogayevskaya St. 56 A 194356
 St. Petersburg, Russia
 EN ISO 13485:2014 AP
 The Hague The Netherlands

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 ТШ 21.20.23-106-94568735-2021
 16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы
 Реагент №1 : 1 x 45 мл
 Реагент №2 : 1 x 15 мл
 Сериясы: 0094
 Шығарылған күні: 2023.05
 Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АҚ Ресей,
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 56-й лит. А



13062305000094

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 REF B 13.06
 REF B 13.16
 45 МЛ
 LOT 0094
 Годен до: 2025.05
 Дейн жарамды: 2025.05
 только для in vitro диагностики
 тек in vitro диагностикасы үшін
 CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 REF B 13.06
 REF B 13.16
 15 МЛ
 LOT 0094
 Годен до: 2025.05
 Дейн жарамды: 2025.05
 только для in vitro диагностики
 тек in vitro диагностикасы үшін
 CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.16

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Серия: 0094
Дата выпуска: 2023.05
Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml
R2: 2 x 15 ml

LOT 0094

2025.05

Vita Development Corporation
Dorogaya Kamenny 55 A 194356
St. Petersburg, Russia

EVERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514 AP
The Hague, The Netherlands

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
55-й, литер А



13162305000094

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1
REF B 13.06
REF B 13.16
45 МЛ
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 1
REF B 13.06
REF B 13.16
45 МЛ
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
REF B 13.06
REF B 13.16
15 МЛ
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
РЕАГЕНТ 2
REF B 13.06
REF B 13.16
15 МЛ
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
CE Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.86

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
 Реагент №2: 1 x 15 мл
 Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
 РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0094
 Дата выпуска: 2023.05
 Годен до: 2025.05
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 дом 55, литера А

только для in vitro диагностики
 UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL
 R1: 1 x 45 ml
 R2: 1 x 15 ml
 Calibrator: 1 vial
 LOT 0094
 IVD 2025.05

K2 LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 ТШ 21.20.23-106-94568735-2021
 16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы
 Реагент №1 : 1 x 45 мл
 Реагент №2 : 1 x 15 мл
 Калибратор: 1 құты

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ
 "Витал Девелопмент Корпорэйшн", АҚ Ресей,
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
 дом 55, литера А



13862305230094

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 REF B 13.86
 REF B 13.96
 45 мл
 LOT 0094
 Годен до: 2025.05
 Дейн жарамды: 2025.05
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 REF B 13.86
 REF B 13.96
 15 мл
 LOT 0094
 Годен до: 2025.05
 Дейн жарамды: 2025.05
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
 2,82ммоль/л(109 мг/дл)
 лиофилизат
 р-ра, содержащая 1,0 мл диспергатора в 1,0 мл диспергатора
 LOT 1423
 Годен до: 2025.06
 Дейн жарамды: 2025.06
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.96

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

Антела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0094
Дата выпуска: 2023.05
Годен до: 2025.05
АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 58, литер А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL
R1: 2 x 45 ml
R2: 2 x 15 ml
Calibrator: 1 vial
G094
2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
УШ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы
Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл
Калибратор: 1 құты
Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

ВИЧ-1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ
"Витал Девелопмент Корпорейшн", АО Ресей,
194358 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литер А



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.86 REF В 13.96
РЕАГЕНТ 1 45 мл 2°C 8°C
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.86 REF В 13.96
РЕАГЕНТ 1 45 мл 2°C 8°C
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.86 REF В 13.96
РЕАГЕНТ 2 15 мл 2°C 8°C
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.86 REF В 13.96
РЕАГЕНТ 2 15 мл 2°C 8°C
LOT 0094
Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
2,02 ммоль/л (109 мг/дл)
ЛИОФИЛИЗАТ
15 мл 2°C 8°C
LOT 1423
Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06
только для in vitro диагностики
только для in vitro диагностики

REF B 13.76-1.150

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0094

IVD 2025.05

Vital Development Corporation
Doroga в Каменку, 56 А, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 40 мл

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBATG вирусына антиденелер жоқ

тек in vitro диагностикасы үшін

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

80032303140092

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.150

14,5 мл

РЕАГЕНТ 2



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшінВитал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.150

14,5 мл

РЕАГЕНТ 2



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшінВитал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.150

40 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшінВитал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.150

40 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейн жарамды: 2025.05только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшінВитал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

2,82 ммоль/л (109 мг/дл)

лиофилизат

РЗН (сыворотка, в 1,5 мл депосекстрированной плазмы)
1,5 мл депосекстрированной плазмы (сыворотка)

LOT 1423

Годен до: 2025.06
Дейн жарамды: 2025.06только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

REF B 13.706-1.150

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 14,5 мл

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

LOT

0094



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 2 x 40 мл
Реагент №2 : 2 x 14,5 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А



80032104140077

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.150

40 мл

LOT 0094



Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.150

40 мл

LOT 0094



Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.150

14,5 мл

2 °C 8 °C

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.150

14,5 мл

2 °C 8 °C

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 13.76-1.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 7 мл

Калибратор: 1 флакон

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0094 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 ml

R2: 4 x 7 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0094

IVD 2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЭН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 4 x 20 мл

Реагент №2: 4 x 7 мл

Калибратор: 1 құты

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



80222304140093



LDL 2

LDL 2

РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.200

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL 2

РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.200

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL 2

КАЛИБРАТОР

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

2.32ммоль/л(109 мг/дл)

лиофилизат

растворить в 1,0 мл дистиллированной воды

1,0 мл дистиллированной воды сразу перед

LOT 1423

годен до: 2025.06

Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін



РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.200

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.200

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 13.706-1.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 4 x 20 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 4 x 7 мл

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 20 мл

R2: 4 x 7 мл

LOT 0094

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестеринің концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 20 мл

Реагент №2 : 4 x 7 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А



80032104140077

LDL 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



LDL 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



LDL 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



LDL 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 1

20 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



LDL 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 2

LDL 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



LDL 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200

РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



РЕАГЕНТ 2

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.200



РЕАГЕНТ 2

7 мл

LOT 0094

годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей



REF B 13.76-1.300

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 3 x 50 мл

Реагент №2: 3 x 18 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:



Дата выпуска:



Годен до:

0094

2023.05

2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml

R2: 3 x 18 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0094

IVD 2025.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық өдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Реагент №1: 3 x 50 мл

Реагент №2: 3 x 18 мл

калибратор: 1 құты

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ
тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



81022304140093



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05

Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

КАЛИБРАТОР LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

2,62 ммоль/л (109 мг/дл)
лиофилизат

растворять в 1,2 мл дистиллированной воды
1,2 мл дистиллированной воды + 1,2 мл калибратора

LOT 1423

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Vital Development

REF B 13.706-1.300

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 3 x 50 мл
Реагент №2: 3 x 18 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Серия: 0094
Дата выпуска: 2023.05
Годен до: 2025.05

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml
R2: 3 x 18 ml

LOT 0094

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 3 x 50 мл
Реагент №2 : 3 x 18 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн", АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
56-й, литер А



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 1 50 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.706-1.300

РЕАГЕНТ 2 18 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF B 13.76-1.420

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 64 мл
Реагент №2: 2 x 23 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0094 Дата выпуска: 2023.05 Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml
R2: 2 x 23 ml
Calibrator: 1 vial

LOT 0094

IVD 2025.05

Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТШ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған

реагенттер жинағы

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

Реагент №1: 2 x 64 мл
Реагент №2: 2 x 23 мл

Калибратор: 1 құты ВИЧ - 1,2 және гепатит С және HBsAg вирусына антиденелер жоқ

тек in vitro диагностикасы үшін



82032304140093



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.420

РЕАГЕНТ 1 64 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.420

РЕАГЕНТ 1 64 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ, Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.420

РЕАГЕНТ 2 23 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-1.420

РЕАГЕНТ 2 23 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ, Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

2,32 ммоль/л (109 мг/дл)

лиофилизат

Ресурсы: 1,18 мл дистиллированной воды
1,0 мл дистиллированной воды, сука еріткіші

LOT 1423

Годен до: 2025.06
Дейін жарамды: 2025.06


только для in vitro диагностики
тек in vitro диагностикасы үшін



REF В 13.706-1.420

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения



Реагент №1: 2 x 64 мл
Реагент №2: 2 x 23 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml
R2: 2 x 23 ml

LOT

0094



Vital Development Corporation
Doroga / Kamenu, 58 A / 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 г. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтардың холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 2 x 64 мл
Реагент №2: 2 x 23 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейім жарамды: 2025.05

тоқтату үшін in vitro диагностика үшін

"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 58, литера А



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.420

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейім жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.420

РЕАГЕНТ 1

64 мл

LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейім жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АҚ, Россия



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.420

23 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейім жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.420

23 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейім жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорейшн" АҚ, Россия



REF В 13.76-2.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 1 x 40 мл

Реагент №2: 1 x 14 мл

ТУ 21.20.23-108-8488735-2021

РЗН 2021/15088 от 18.08.2021

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Канонерку,
дом 55, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 40 ml

R2: 1 x 14 ml

LOT

0094



АО "Витал Девелопмент Корпорейшн"
Дорога в Канонерку, дом 55, литера А
Санкт-Петербург, Россия

MD

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-108-8488735-2021
18.08.2021 г. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шегіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жиыналы

Реагент №1 : 1 x 40 мл

Реагент №2 : 1 x 14 мл

Сериясы: 0094

Шығарылған күні: 2023.05

Дейін жарамды: 2025.05

"Витал Девелопмент Корпорейшн", АО, Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Канонерку, дом 55, литера А

только для in vitro диагностики



54032104140077

3

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.200

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT

0094



Годен до: 2025.05

Действ. жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.200

РЕАГЕНТ 2

14 мл

25 °C

LOT

0094

Годен до: 2025.05

Действ. жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия
"Витал Девелопмент Корпорейшн" АО, Россия

REF В 13.716-2.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 3 x 16 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 1 x 16 мл

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT

Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 16 ml

R2: 1 x 16 ml

LOT

0094



Vital Development Corporation
Dorogaya v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2025.05

IVD

K2 LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1: 3 x 16 мл

Реагент №2: 1 x 16 мл

Сериясы: 0094

Шығарылған күні: 2023.05

Дейін жарамды: 2025.05

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

тек in vitro диагностикасы үшін



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.716-2.200

РЕАГЕНТ 1

16 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.716-2.200

РЕАГЕНТ 1

16 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.716-2.200

РЕАГЕНТ 1

16 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.716-2.200

РЕАГЕНТ 2

16 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

REF В 13.76-2.300

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 4 x 45 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 30 мл

РЗН 2021/15088 от 16.08.2021

LOT Серия: 0094



Дата выпуска: 2023.05



Годен до: 2025.05

только для in vitro диагностики

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 45 ml

R2: 2 x 30 ml

LOT 0094

Vital Development Corporation
Dorogaya Kamenny, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2025.05

KZ LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
16.08.2021 ж. РЗН 2021/15088

Қан сарысуындағы (плазмадағы) төмен тығыздықтағы липопротеидтердің холестерині концентрациясын бойынша шөгіндісіз, селективті қорғанысы бар энзиматикалық колориметриялық әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы

Реагент №1 : 4 x 45 мл

Реагент №2 : 2 x 30 мл

Сериясы: 0094
Шығарылған күні: 2023.05
Дейін жарамды: 2025.05

тек in vitro диагностикасы үшін

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" АҚ Ресей,
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А



83022104140077

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 2 30 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 2 30 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-2.300

РЕАГЕНТ 1 45 мл



LOT 0094

Годен до: 2025.05
Дейін жарамды: 2025.05

только для in vitro диагностики

тек in vitro диагностикасы үшін

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия
"Витал Девелопмент
Корпорэйшн" АҚ Ресей

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

16

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов



2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения «LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF В 13.06

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой без осаждения

Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.06



Годен до:
2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml


R2: 1 x 15 ml

LOT 0011




Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2022.06



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



13062102000078


LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.06
REF В 13.16

45 МЛ

LOT 0011

Годен до: 2022.06



РЕАГЕНТ 2 LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
15 МЛ
LOT 0011
Годен до: 2022.06

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.16

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0011

Дата выпуска: 2020.06

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml

R2: 2 x 15 ml


LOT 0011

2022.06

IVD

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, The Netherlands



13162102000076


LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

45 МЛ

LOT 0011

Годен до: 2022.06

CE



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

15 МЛ

LOT 0011

Годен до: 2022.06

CE



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.86

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения



Реагент №1: 1 x 45 мл
Реагент №2: 1 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 45 ml

R2: 1 x 15 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0011

IVD

Годен до: 2022.06

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A. 194356
St. Petersburg, Russia



13862103140077




LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.86
REF B 13.96

45 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.06

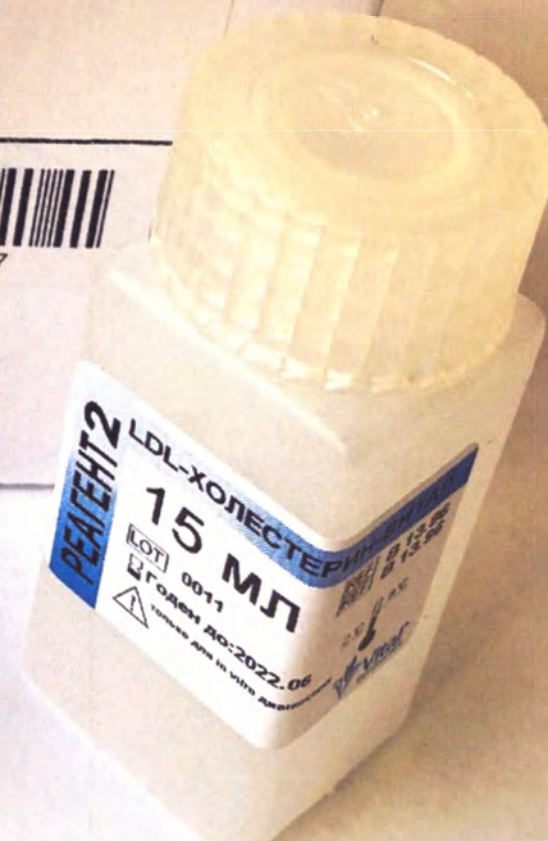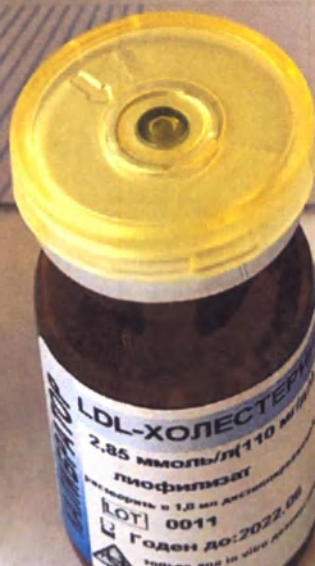

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ REF B 13.96

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 45 мл
Реагент №2: 2 x 15 мл
Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 45 ml

R2: 2 x 15 ml

Calibrator: 1 vial

LOT 0011



Vital Development Corporation
Doroga - Kamenuk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

2022.06



13862103

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.86
REF B 13.96

45 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



REF В 13.76-1.150
LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 14,5 мл
Калибратор: 1 флакон

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0011 Дата выпуска: 2020.06 Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 14,5 ml
Calibrator: 1 vial

LOT 0011

2022.06

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.76-1.150
14,5 мл

РЕАГЕНТ 2
LOT 0011
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.76-1.150
40 мл
РЕАГЕНТ 1
LOT 0011
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF В 13.706-1.150

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации холестерина
липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме)
крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C
с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 40 мл
Реагент №2: 2 x 14,5 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.06



Годен до:
2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 40 ml

R2: 2 x 14,5 ml

LOT 0011



Vital Development Corporation
Doroga - Kamenskiy 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2022.06

IVD



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.150

14,5 мл



LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.706-1.150

40 мл

LOT 0011


Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



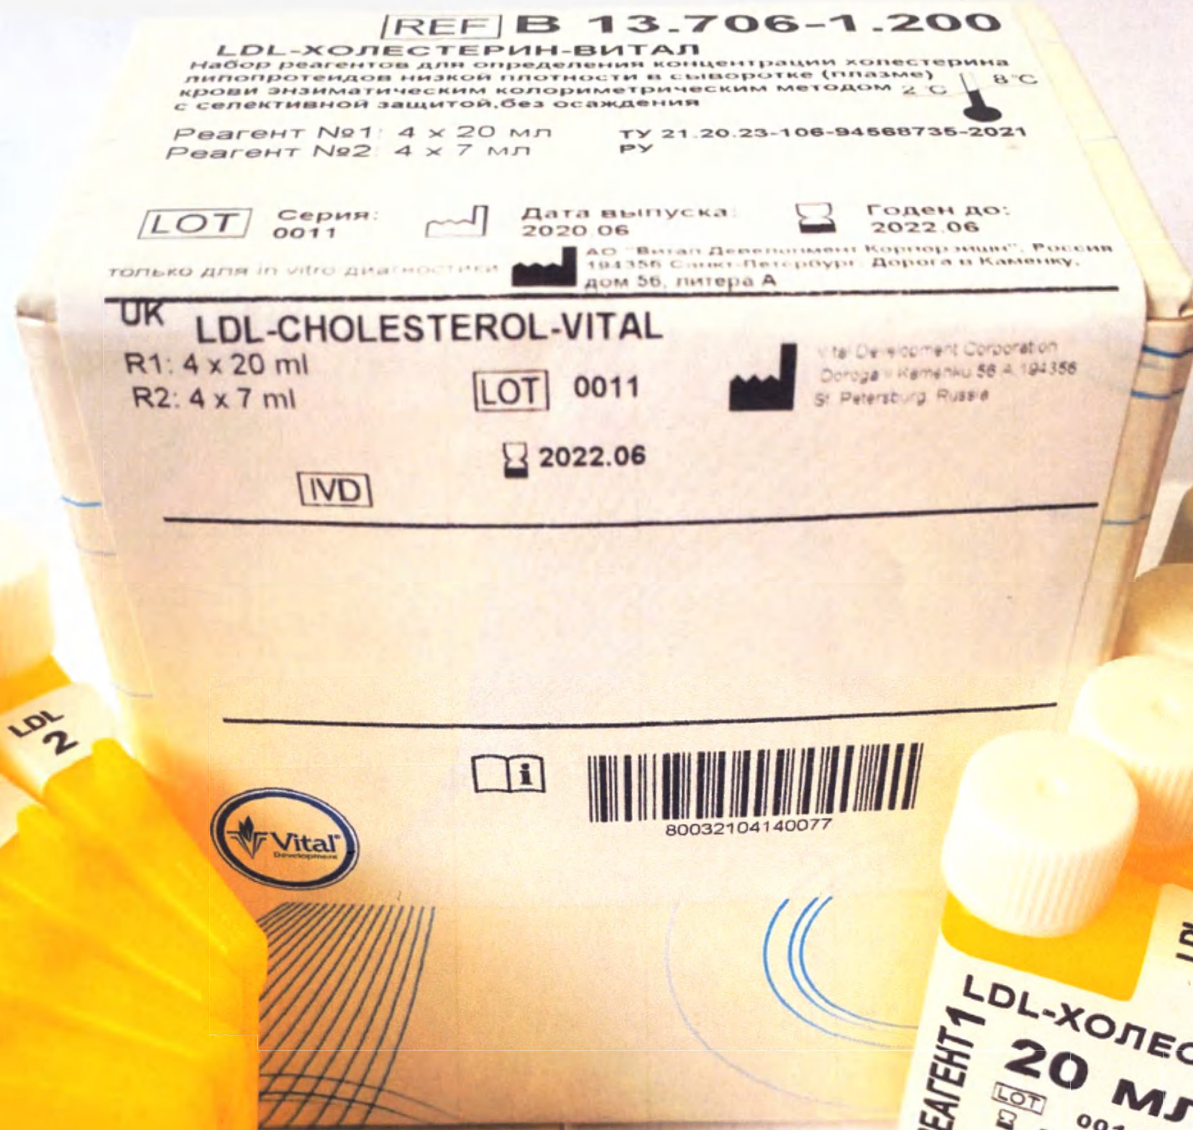



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
[REF] В 13.76-1.300
Набор реагентов для определения концентрации холестерина
липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме)
крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °С
с селективной защитой без осаждения

Реагент №1 3 x 50 мл
Реагент №2 3 x 18 мл
Калибратор 1 флакон

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Серия: 0011
LOT 0011

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
Годен до: 2022.06
Дата выпуска: 2020.06

АО Витал Девелопмент Корпорейшн
194256 Санкт-Петербург, Дорная и Каменка
дом 56, литера А

LDL-CHOLESTEROL-VITAL
R1: 3 x 50 ml
R2: 3 x 18 ml
Calibrator: 1 vial
LOT 0011
2022.06

только для in vitro диагностики

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
[REF] В 13.76-1.300

РЕАГЕНТ 1 **50 мл**
LOT 0011
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

LDL 1

LDL 1

LDL 1

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
[REF] В 13.76-1.300
18 мл
РЕАГЕНТ 2
LOT 0011
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
[REF] В 13.76-1.300
18 мл
РЕАГЕНТ 2
LOT 0011
Годен до: 2022.06
только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 13.706-1.300

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C 8 °C с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 3 x 50 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 3 x 18 мл

РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 50 ml

R2: 3 x 18 ml

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.06

IVD



60032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.706-1.300
LOT 0011
50 МЛ
Годен до: 2022.06
2 °C 8 °C
только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия

РЕАГЕНТ 1



REF В 13.76-1.420

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови. Энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения.

Реагент №1: 2 x 64 мл

Реагент №2: 2 x 23 мл

Калибратор: 1 флакон

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:

0011



Дата выпуска:

2020.06



Годен до:

2022.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml

R2: 2 x 23 ml

Calibrator: 1 vial

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2022.06

IVD

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-1.420

23 мл

РЕАГЕНТ 2

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



80032104140077

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.76-1.420

64 мл

РЕАГЕНТ 1

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 13.706-1.420

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C 8 °C с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 2 x 64 мл
Реагент №2: 2 x 23 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 2 x 64 ml
R2: 2 x 23 ml

LOT 0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2022.06

IVD



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.706-1.420

64 мл

LOT 0011

Годен до: 2022.06

2 °C 8 °C

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF В 13.706-1.420

23 мл

2 °C 8 °C

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 13.76-2.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 14 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 14 ml

LOT

0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia




2022.06

IVD



80032104140077

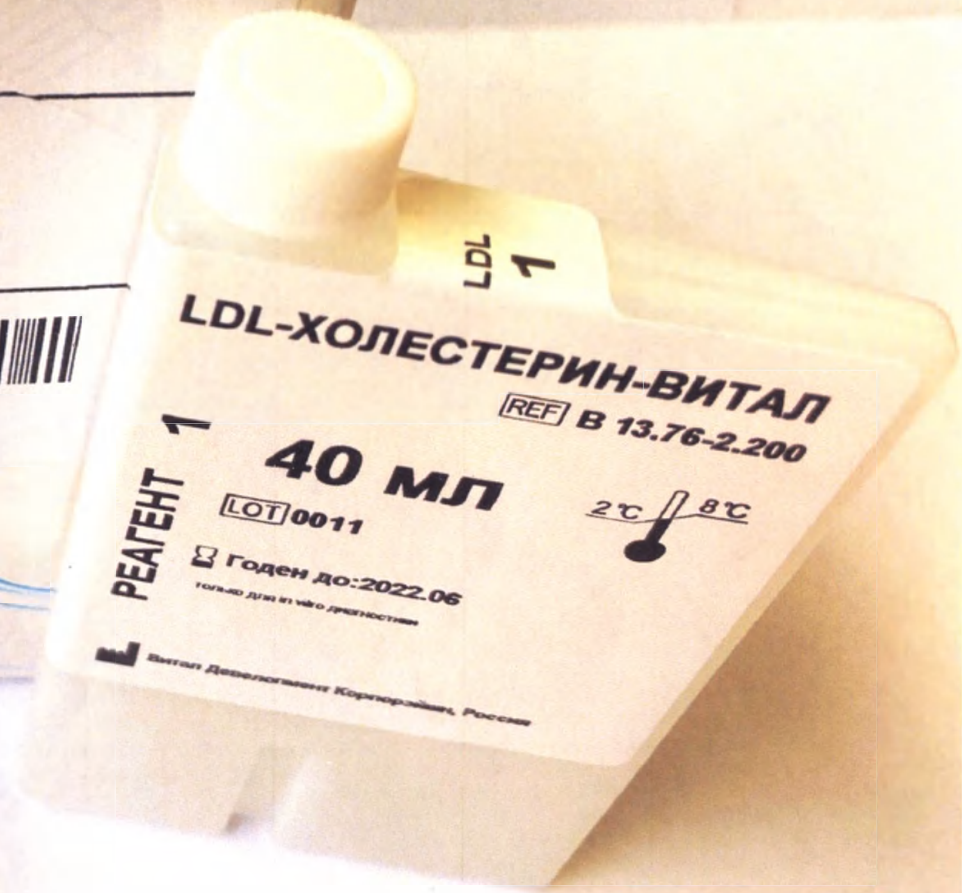

REF В 13.716-2.200

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
Набор реагентов для определения концентрации холестерина
липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме)
крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C
с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 3 x 16 мл
Реагент №2: 1 x 16 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021
РУ

LOT

Серия:
0011



Дата выпуска:
2020.06



Годен до:
2022.06

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 3 x 16 ml

R2: 1 x 16 ml

LOT 0011



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2022.06

IVD



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.716-2.200
16 мл
2 °C

LOT 0011
Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ
REF В 13.716-2.200
16 мл
2 °C

LOT 0011
Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
корпорэйшн, Россия

REF B 13.76-2.300

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом 2 °C 8 °C с селективной защитой, без осаждения

Реагент №1: 4 x 45 мл

ТУ 21.20.23-106-94568735-2021

Реагент №2: 2 x 30 мл

РУ

LOT

Серия: 0011



Дата выпуска: 2020.06



Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А

UK LDL-CHOLESTEROL-VITAL

R1: 4 x 45 ml

R2: 2 x 30 ml

LOT 0011

2022.06

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 58 A, 194356
St. Petersburg, Russia



80032104140077



LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

45 мл

2 °C 8 °C

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

45 мл

2 °C 8 °C

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

30 мл

2 °C 8 °C

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ

REF B 13.76-2.300

30 мл

2 °C 8 °C

LOT 0011

Годен до: 2022.06

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 16 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

