



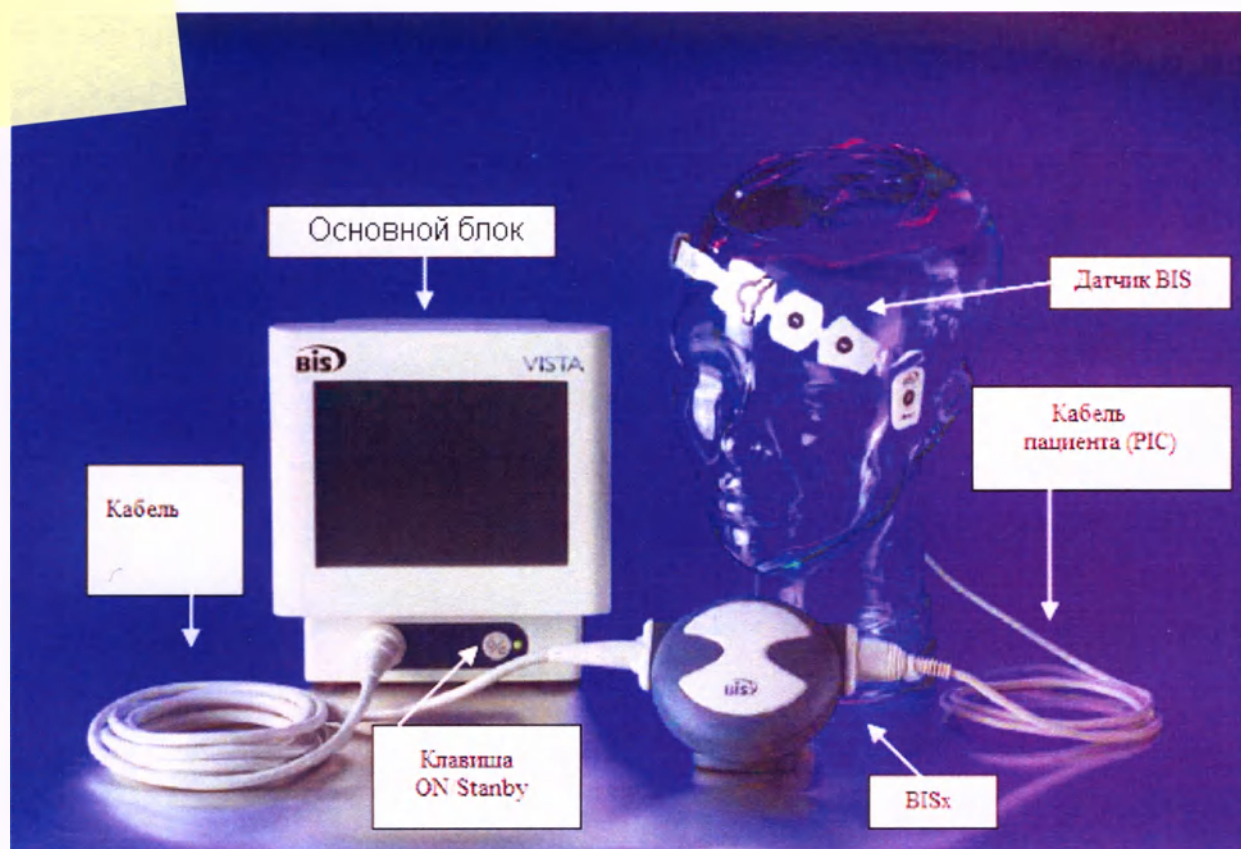


Система мониторинга глубины наркоза и седации BIS Vista с принадлежностями

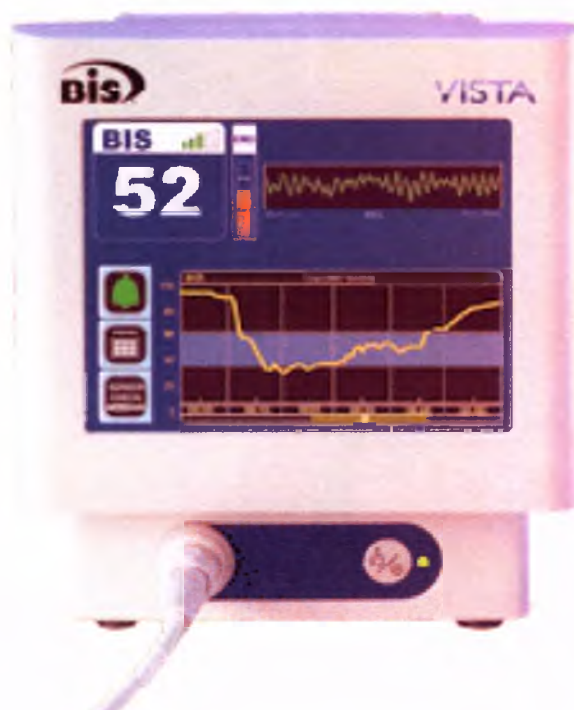

Основной блок BIS Vista

АКТ № 480-Р/11

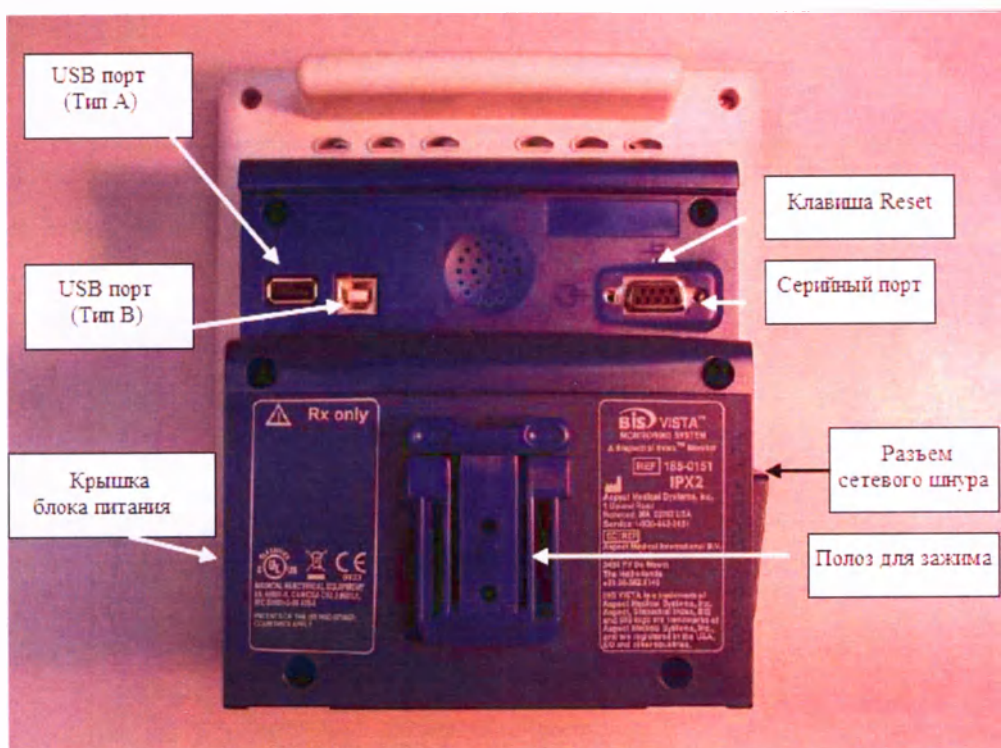


Задняя панель Основного блока BIS Vista



Способ крепления

АКТ № 480-Р/11

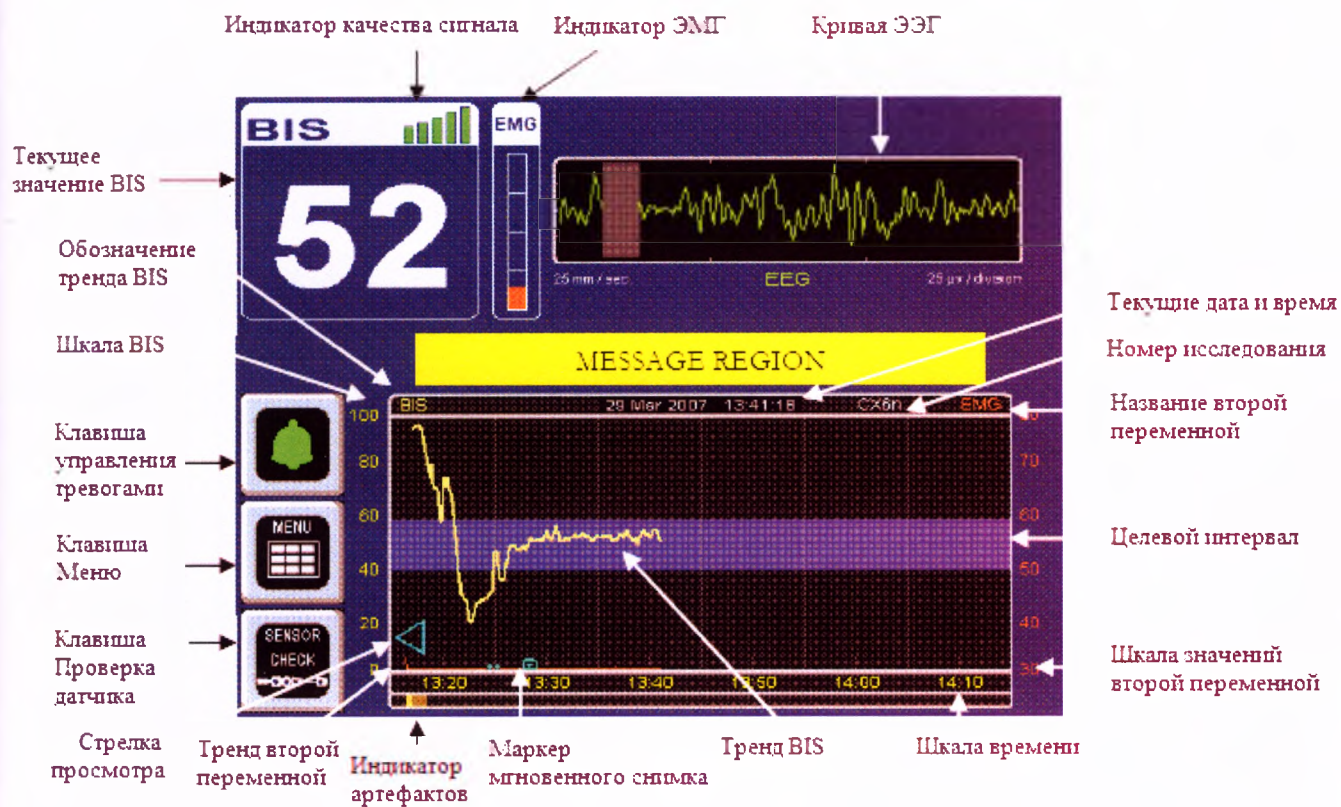

Панель дисплея Основного блока



Цифровой преобразователь сигнала с кабелем для соединения с основным блоком