

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев


« 18 » апреля 2021 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к
Treponema pallidum «Инвитролоджик Сиф-АТ» по ТУ 9398-014-26329720-2008»**

Комплект 3 на 96 определений, смешанный состав

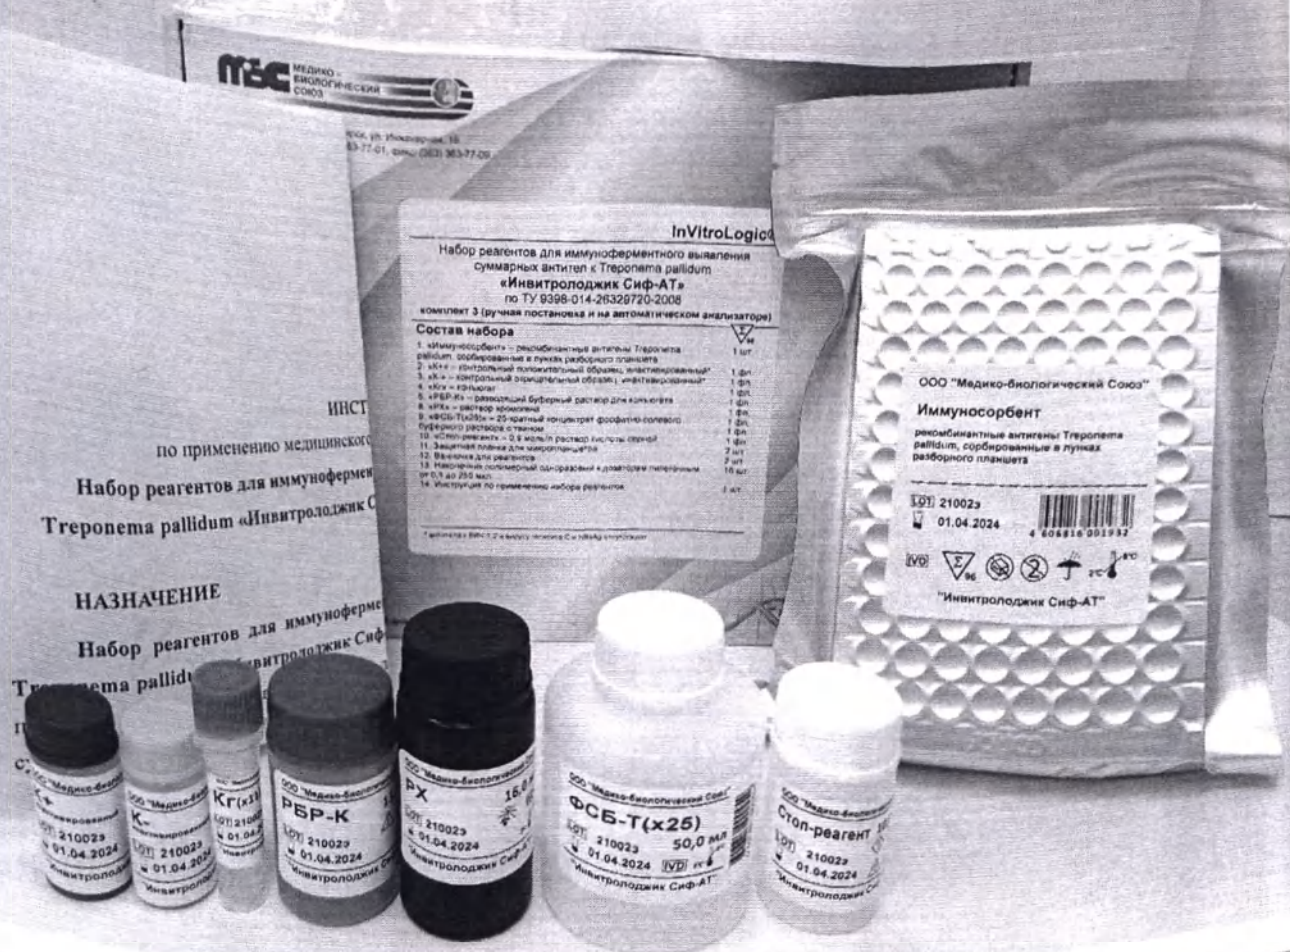

REF LB-313



LOT 210023



16.04.2021

Замораживание не допускается



16.04.2023

"Инвитролоджик Сиф-АТ"


комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № ФСР 2009/05331

TY 9398-014-26329720-2008



4 606816003172



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора


1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	1 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	1 фл.
8. «РХ» – раствор хромогена	1 фл.
9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.
10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
11. Защитная плёнка для микропланшетов	2 шт.
12. Ванночка для реагентов	2 шт.
13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	16 шт.
14. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Комплект 3 на 96 определений, двухкомпонентный состав

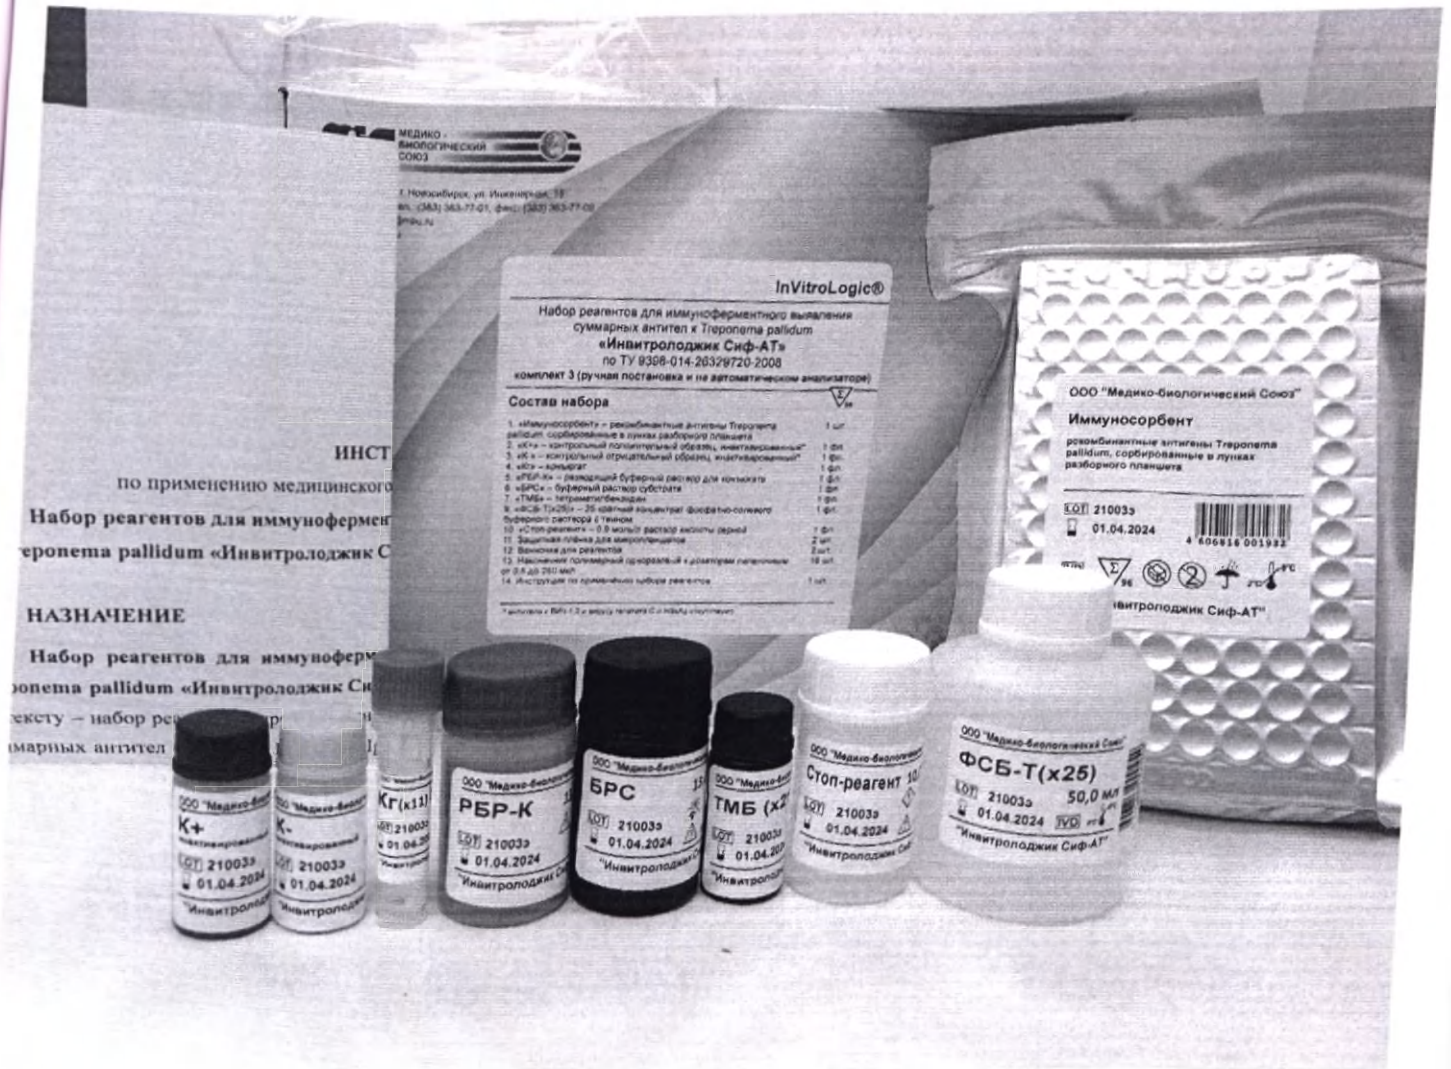

REF LB-312



LOT

210033



16.04.2021

Замораживание не допускается




16.04.2023

"Инвитролоджик Сиф-АТ"


комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



4 606816003172



МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора



1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	1 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	1 фл.
6. «БРС» – буферный раствор субстрата	1 фл.
7. «ТМБ» – тетраметилбензидин	1 фл.
9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.
10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
11. Защитная плёнка для микропланшетов	2 шт.
12. Ванночка для реагентов	2 шт.
13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	16 шт.
14. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.


* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Комплект 3 на 192 определения, смешанный состав

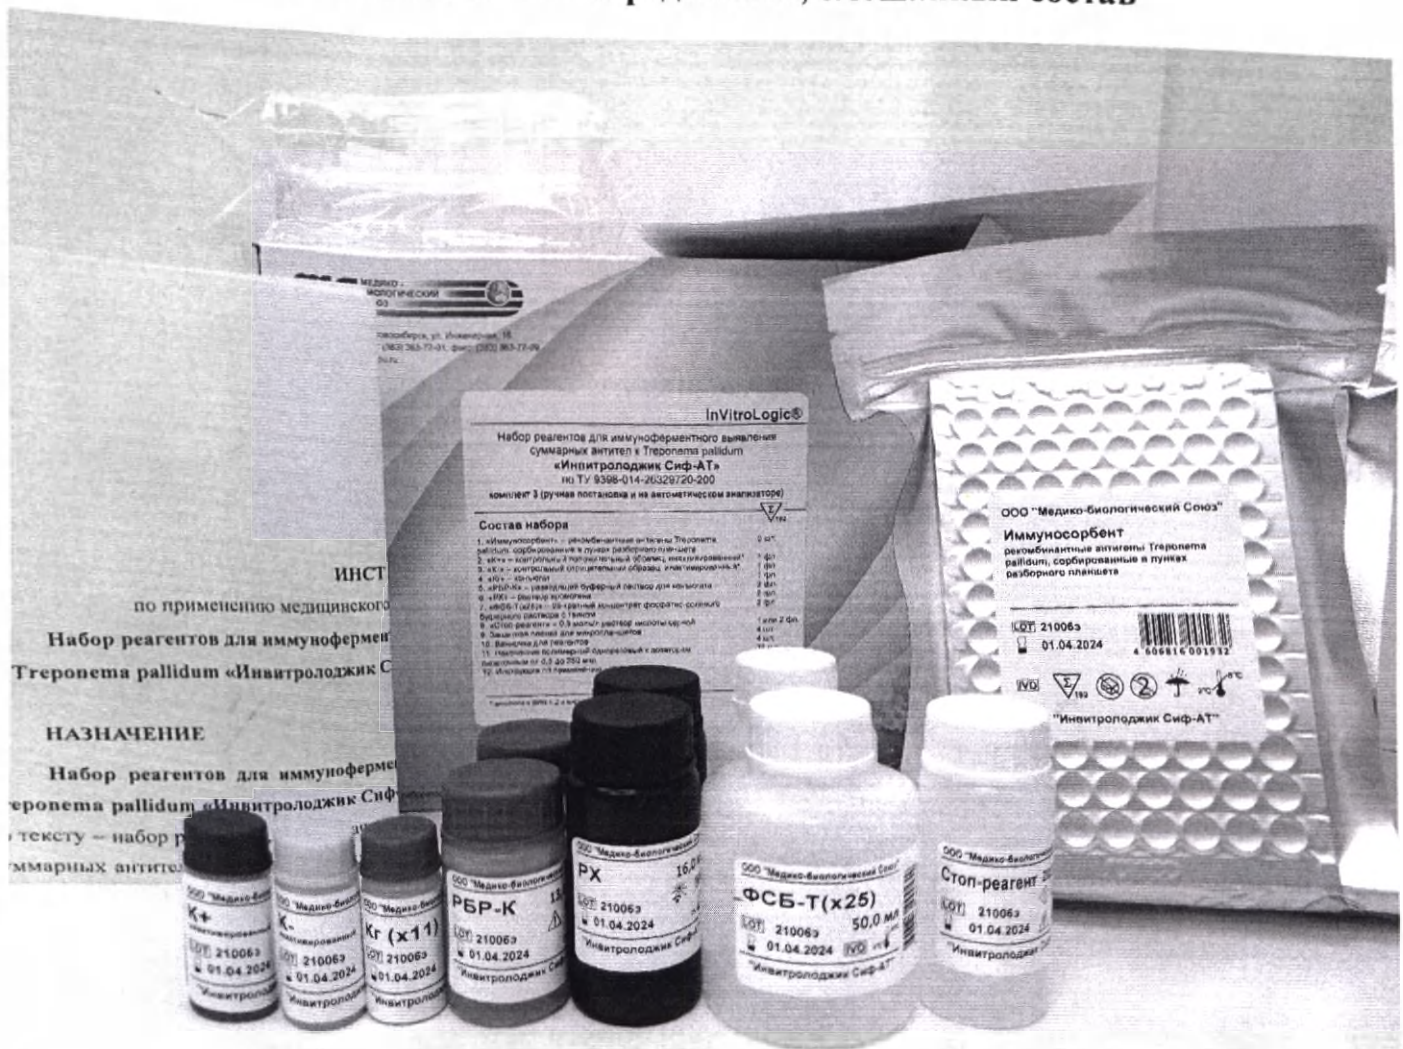

REF LB-323



LOT 21006э



16.04.2021

Замораживание не допускается



16.04.2023

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

ПУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



4 606816003196

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)



Состав набора


1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	2 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	2 фл.
6. «РХ» – раствор хромогена	2 фл.
7. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 или 2 фл.
9. Защитная плёнка для микропланшетов	4 шт.
10. Ванночка для реагентов	4 шт.
11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	32 шт.
12. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Комплект 3 на 192 определения, двухкомпонентный состав

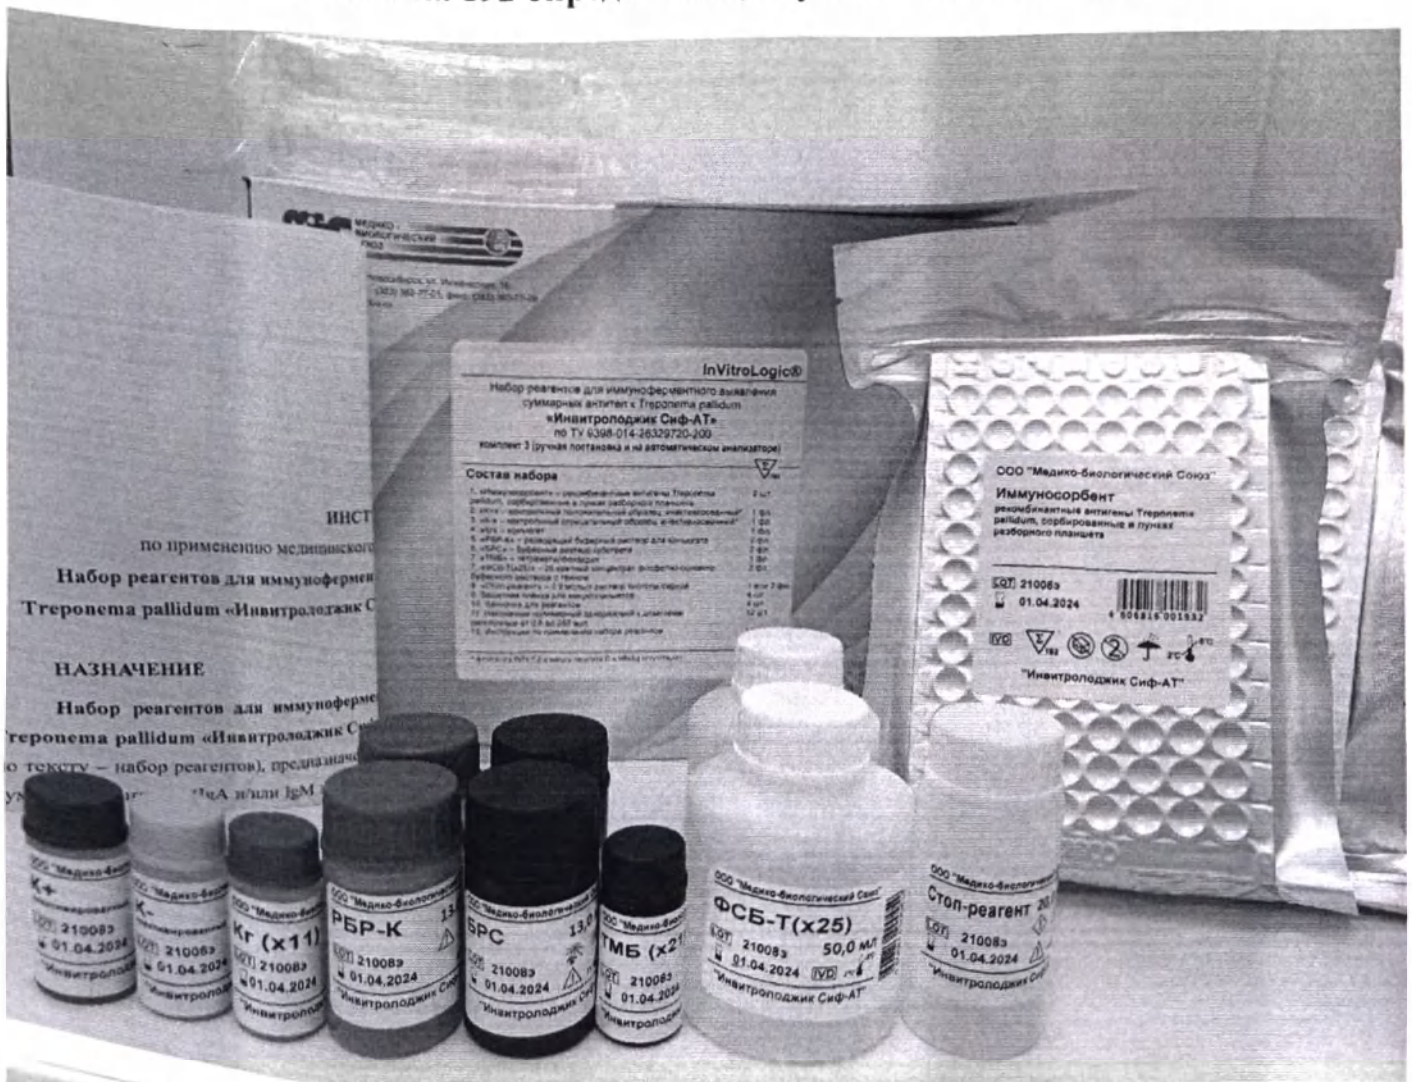

REF LB-322  **LOT 21008э**  **16.04.2021**
 Замораживание не допускается  **16.04.2023**

"Инвитролоджик Сиф-АТ"
 комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № ФСР 2009/05331    4 606816003196
 ТУ 9398-014-26329720-2008  

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора




1. «Иммунсорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	2 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	2 фл.
6. «БРС» – буферный раствор субстрата	2 фл.
7. «ТМБ» – тетраметилбензидин	1 фл.
7. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 или 2 фл.
9. Защитная плёнка для микропланшетов	4 шт.
10. Ванночка для реагентов	4 шт.
11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	32 шт.
12. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Комплект 3 на 480 определений, смешанный состав

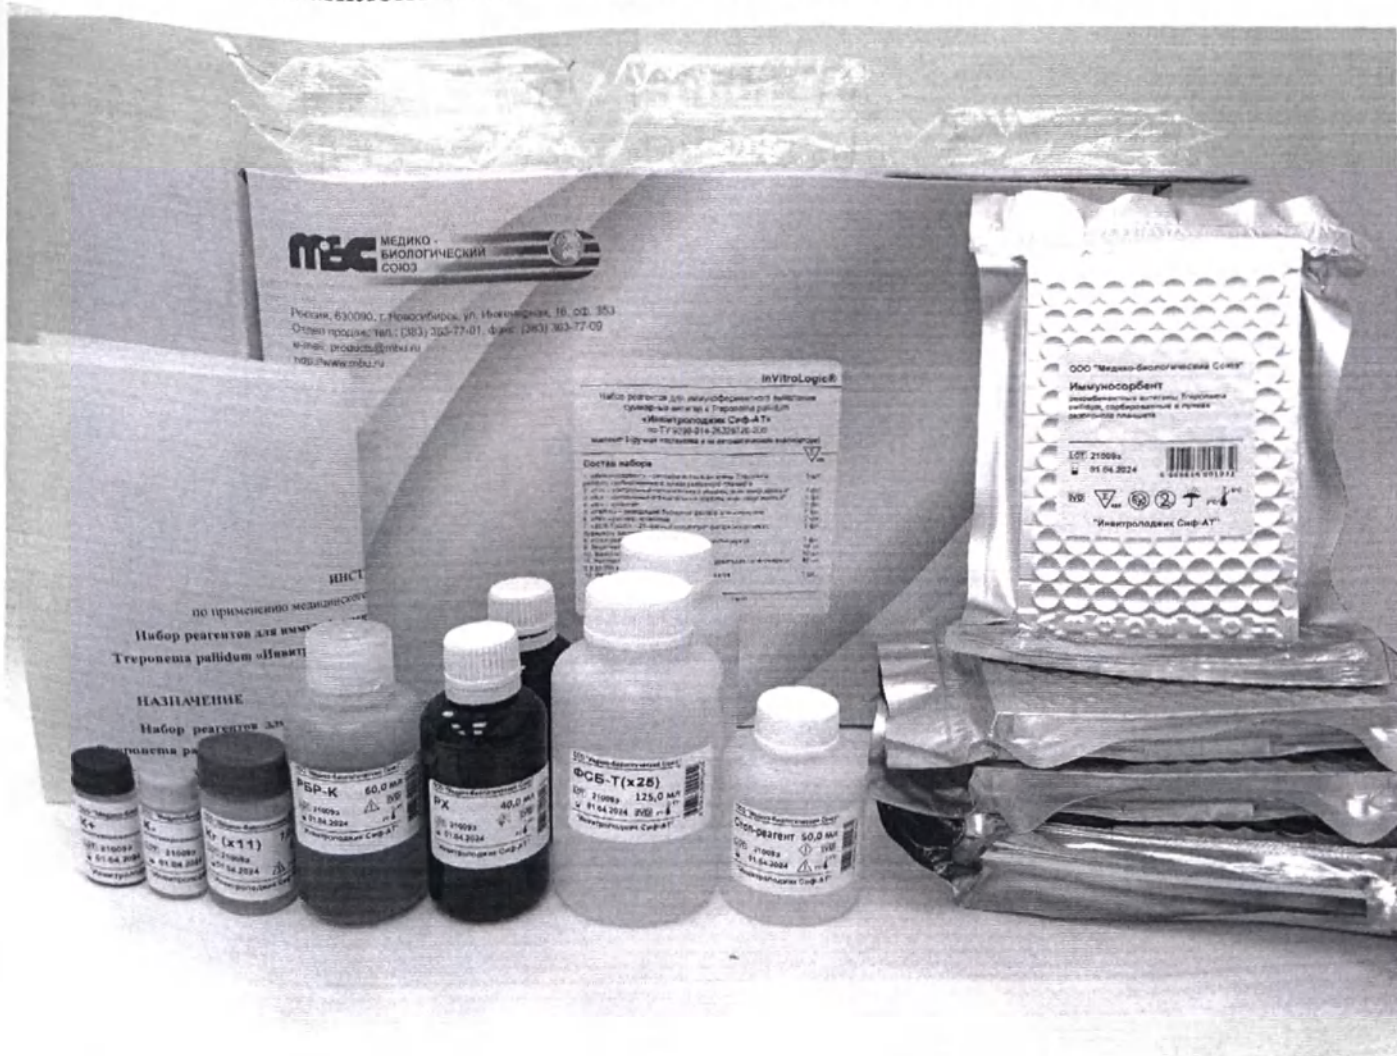

REF LB-353



LOT 21009з



16.04.2021

Замораживание не допускается



16.04.2023

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)


РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



4 606816003202





Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)


Состав набора

1. «Иммунсорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	5 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кл» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	1 фл.
6. «РХ» – раствор хромогена	2 фл.
7. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
9. Защитная пленка для микропланшетов	10 шт.
10. Ванночка для реагентов	10 шт.
11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам липецким от 0,5 до 250 мкл	80 шт.
12. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.


* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

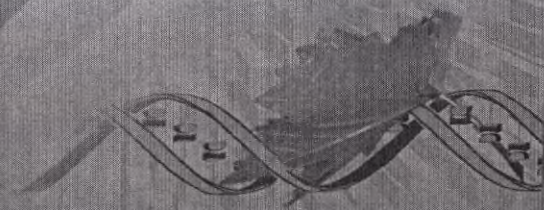

Комплект 3 на 480 определений, двухкомпонентный состав

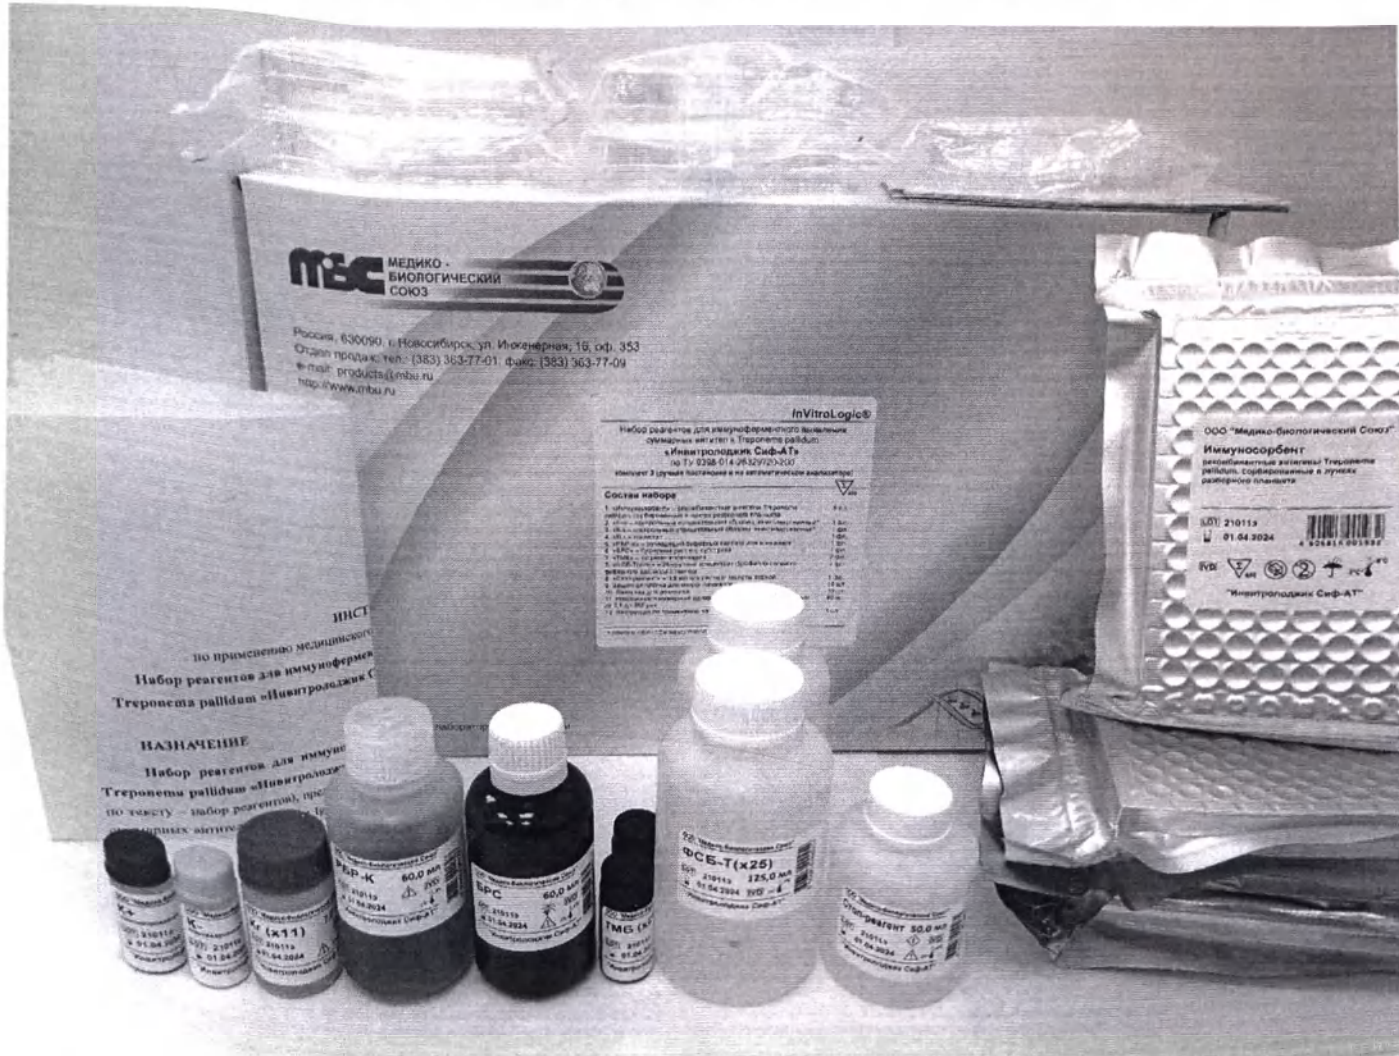


REF LB-352 Σ 480 LOT 210113 16.04.2021
 Замораживание не допускается 16.04.2023

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

ПУ № ФСР 2009/05331
 ТУ 9398-014-26329720-2008



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора

1 «Иммунсорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	5 шт.
2 «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3 «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4 «Кк» – конъюгат	1 фл.
5 «БР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	1 фл.
6 «БРС» – буферный раствор субстрата	1 фл.
7 «ТМБ» – тетраметилбензидин	2 фл.
7 «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8 «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
9 Защитная пленка для микропланшетов	10 шт.
10 Ванночка для реагентов	10 шт.
11 Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	80 шт.
12 Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антигена к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (15) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«16» 2021 г.




Образцы маркировки медицинского изделия

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к
Трепонема pallidum «Инвитролоджик Сиф-АТ» по ТУ 9398-014-26329720-2008»**

Внешняя маркировка
Комплект 3 на 96 определений, смешанный состав:

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж, тел. (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitoLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора

1. «Иммунсорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	1 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	1 фл.
8. «РХ» – раствор хромогена	1 фл.
9. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.
10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 фл.
11. Защитная плёнка для микропланшетов	2 шт.
12. Ванночка для реагентов	2 шт.
13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	16 шт.
14. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX Σ_{96} **LOT** XXXXX XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается


XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"


комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора



- | | |
|---|--------|
| 1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета | 1 шт. |
| 2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 4. «Кг» – конъюгат | 1 фл. |
| 5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата | 1 фл. |
| 6. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 7. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 1 фл. |
| 9. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 1 фл. |
| 10. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 11. Защитная плёнка для микропланшетов | 2 шт. |
| 12. Ванночка для реагентов | 2 шт. |
| 13. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 16 шт. |
| 14. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX



LOT XXXXX



XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается




XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"


комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



Лицевая сторона:



Россия 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
 суммарных антител к *Treponema pallidum*
«Инвитролоджик Сиф-АТ»
 по ТУ 9398-014-26329720-2008
 комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора

1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	2 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	2 фл.
6. «РХ» – раствор хромогена	2 фл.
7. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 или 2 фл.
9. Защитная плёнка для микропланшетов	4 шт.
10. Ванночка для реагентов	4 шт.
11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	32 шт.
12. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX



LOT XXXXX



XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается



XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)


РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



4 606816 003196

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*
«Инвитролоджик Сиф-АТ»
по ТУ 9398-014-26329720-2008
комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

Состав набора

1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета	2 шт.
2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный*	1 фл.
3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный*	1 фл.
4. «Кг» – конъюгат	1 фл.
5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата	2 фл.
6. «БРС» – буферный раствор субстрата	2 фл.
7. «ТМБ» – тетраметилбензидин	1 фл.
7. «ФСБ-Т(x25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.
8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	1 или 2 фл.
9. Защитная плёнка для микропланшетов	4 шт.
10. Ванночка для реагентов	4 шт.
11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл	32 шт.
12. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX



LOT XXXXX



XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается



XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)


РУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



4 606816 003196

Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitoLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*

«Инвитролоджик Сиф-АТ»

по ТУ 9398-014-26329720-2008

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)



Состав набора

- | | |
|--|--------|
| 1. «Иммунсорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 4. «Кг» – конъюгат | 1 фл. |
| 5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата | 1 фл. |
| 6. «РХ» – раствор хромогена | 2 фл. |
| 7. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 9. Защитная плёнка для микропланшетов | 10 шт. |
| 10. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 12. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX



LOT XXXXX



XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается



XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"


комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)

ПУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008



Лицевая сторона:



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

InVitroLogic®

Набор реагентов для иммуноферментного выявления
суммарных антител к *Treponema pallidum*
«Инвитролоджик Сиф-АТ»
по ТУ 9398-014-26329720-2008
комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)



Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. «Иммуносорбент» – рекомбинантные антигены <i>Treponema pallidum</i> , сорбированные в лунках разборного планшета | 5 шт. |
| 2. «К+» – контрольный положительный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 3. «К-» – контрольный отрицательный образец, инактивированный* | 1 фл. |
| 4. «Кг» – конъюгат | 1 фл. |
| 5. «РБР-К» – разводящий буферный раствор для конъюгата | 1 фл. |
| 6. «БРС» – буферный раствор субстрата | 1 фл. |
| 7. «ТМБ» – тетраметилбензидин | 2 фл. |
| 7. «ФСБ-Т(х25)» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. |
| 8. «Стоп-реагент» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной | 1 фл. |
| 9. Защитная плёнка для микропланшетов | 10 шт. |
| 10. Ванночка для реагентов | 10 шт. |
| 11. Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным от 0,5 до 250 мкл | 80 шт. |
| 12. Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

* антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Боковая сторона:

REF XXXXX



LOT XXXXX



XX.XX.XXXX

Замораживание не допускается



XX.XX.XXXX

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

комплект 3 (ручная постановка и на автоматическом анализаторе)


ПУ № ФСР 2009/05331

ТУ 9398-014-26329720-2008







Внутренняя маркировка



Комплект 3 на 96 определений

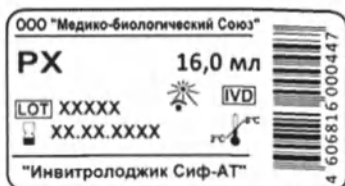

ИЛИ

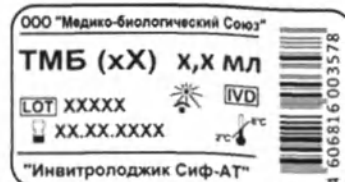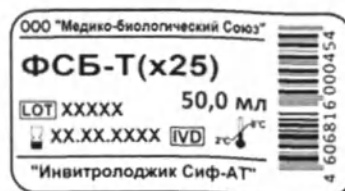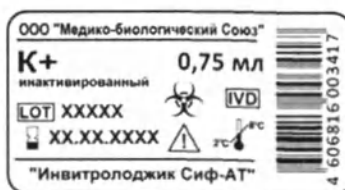

И

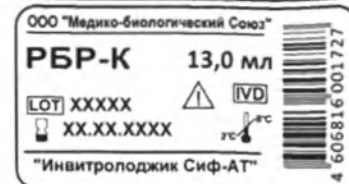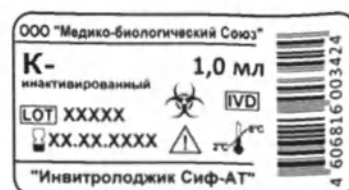

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммунсорбент
рекомбинантные антигены *Treponema pallidum*, сорбированные в лунках разборного планшета

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 001932

IVD

192

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РХ 16,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000447

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(х25) 50,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000454

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К+ 1,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003417

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Кг (хХ) 3,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000423

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 10,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000461

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ИЛИ

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (хХ) х,х мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003578

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

К- 1,5 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003424

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РБР-К 13,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 001727

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 20,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000461

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ИЛИ

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС 13,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003561

IVD

2°C 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

И

ООО "Медико-биологический Союз"

Иммуносорбент
рекомбинантные антигены *Treponema pallidum*, сорбированные в лунках разборного планшета

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 001932

IVD Σ_{480} 2° $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

PX 40,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000447

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

или

ООО "Медико-биологический Союз"

K+ 2,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003417

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

K_г (xX) 7,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000423

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ФСБ-Т(x25) 125,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000454

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

ТМБ (xX) 5,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003578

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

и

ООО "Медико-биологический Союз"

K- 3,0 мл
инактивированный

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003424

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

РБР-К 60,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 001727

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

Стоп-реагент 50,0 мл

LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 000461

IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

ООО "Медико-биологический Союз"

БРС 60,0 мл


LOT XXXXX
XX.XX.XXXX

4 606816 003561



IVD $\text{2}^{\circ}\text{C}$ 8°C

"Инвитролоджик Сиф-АТ"

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

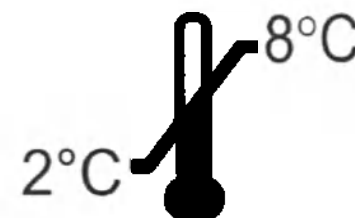

**Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных
антител к Трепонема pallidum «Инвитролоджик Сиф-АТ»
по ТУ 9398-014-26329720-2008
(комплект X)**

Кат. №	XX-XXX
Серия	XXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг
Допускается транспортирование при температуре не выше 27 °С в течение 10 суток	



Срочный груз

Не бросать

Замораживание не допускается



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (51) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев