



навигатор в мире электроники

Общество с ограниченной ответственностью «Дон»
ИНН: 7702045812 / ОГРН: 770301661

ПАО «Промсвязьбанк»
р/сч.: 4070 2810 2300 0002 0049
с/сч.: 3010 1810 4000 0000 0005
БИК: 044525555
ПАО «Сбербанк»
р/сч.: 4070 2810 8300 9000 7046
с/сч.: 3010 1810 4000 0000 0225
БИК: 044525325

Электронная почта: e-mail@don-son.ru
Телефоны: +7 (495) 225-40-31 / +7 (495) 225-40-32 / +7 (495) 225-40-33
Фактический адрес: 127521, г. Москва, Старосадское шоссе, дом 3
Юридический адрес: 129090, г. Москва, улица Щипкина, дом 27, корпус 1

Свидетельство о квалификации № ЭС 01.101.0601-2020 от 23 июня 2020 года, выдано Центральным органом Системы «ЭЛЕКТРОНСЕРТ», действительно до 23 июня 2022 года.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

С.Д. Бабанский




«20» 05 2021 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Аппарат электрохирургический высокочастотный ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1
по ТУ ВУ 100386629.142-2020»**


1

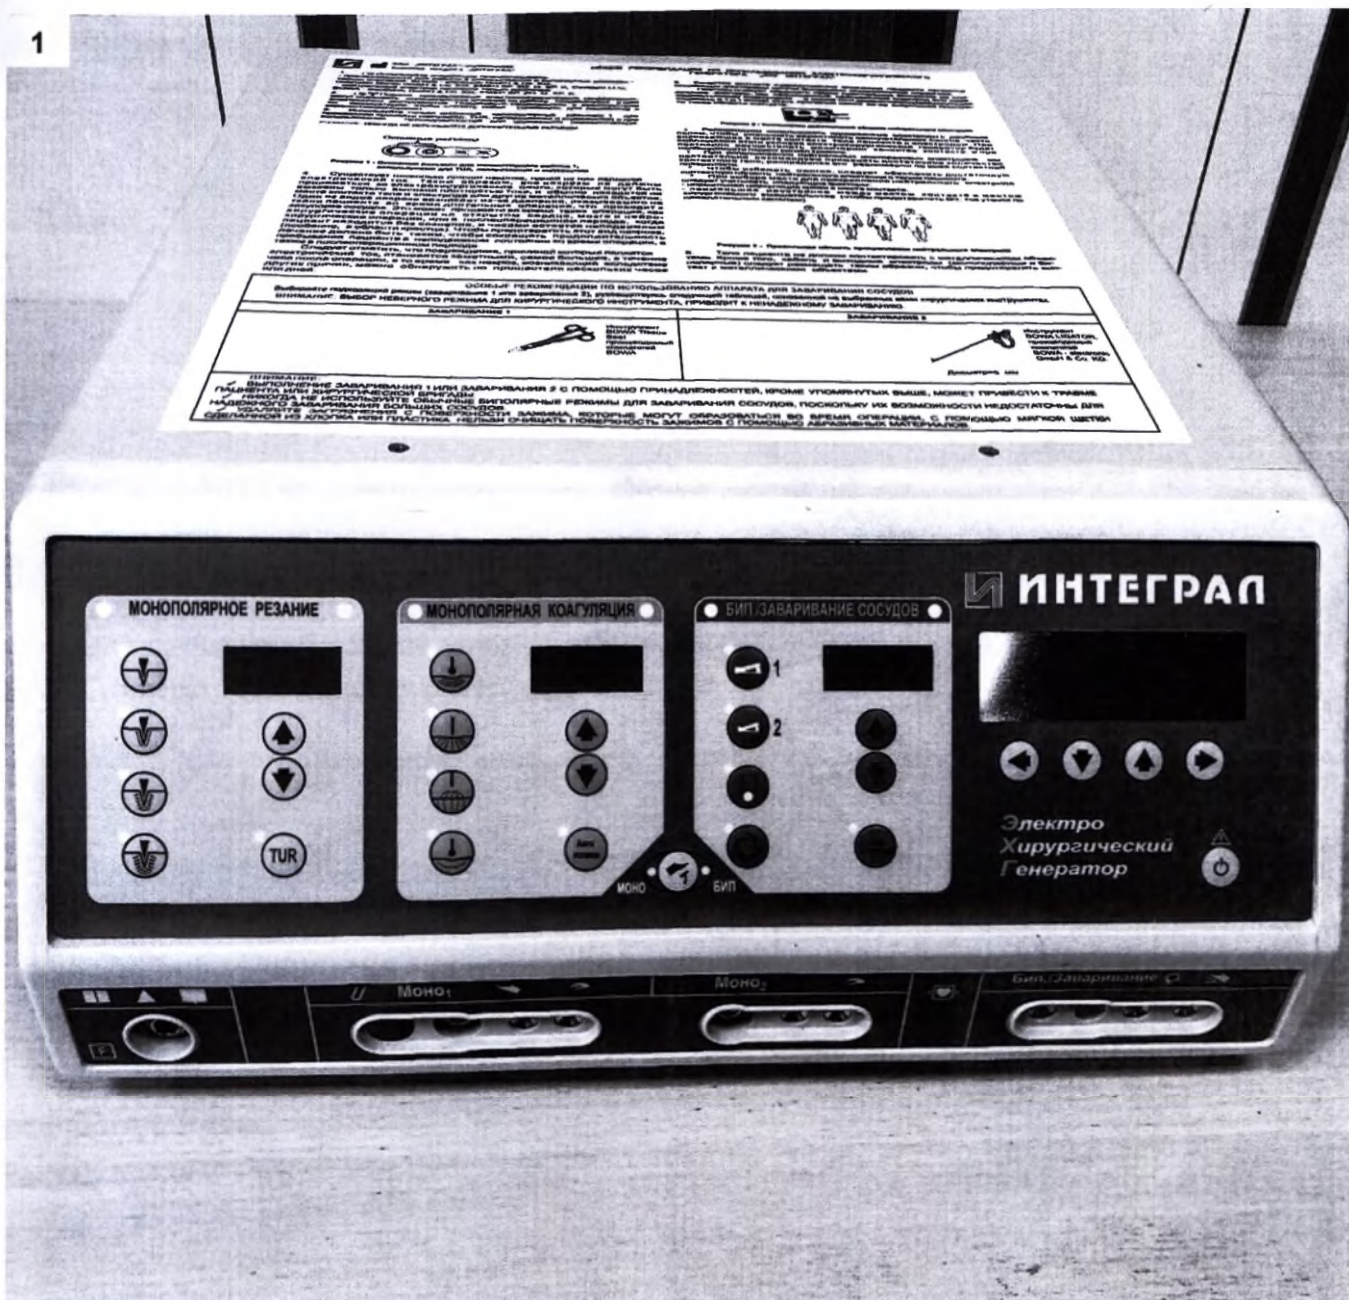


2

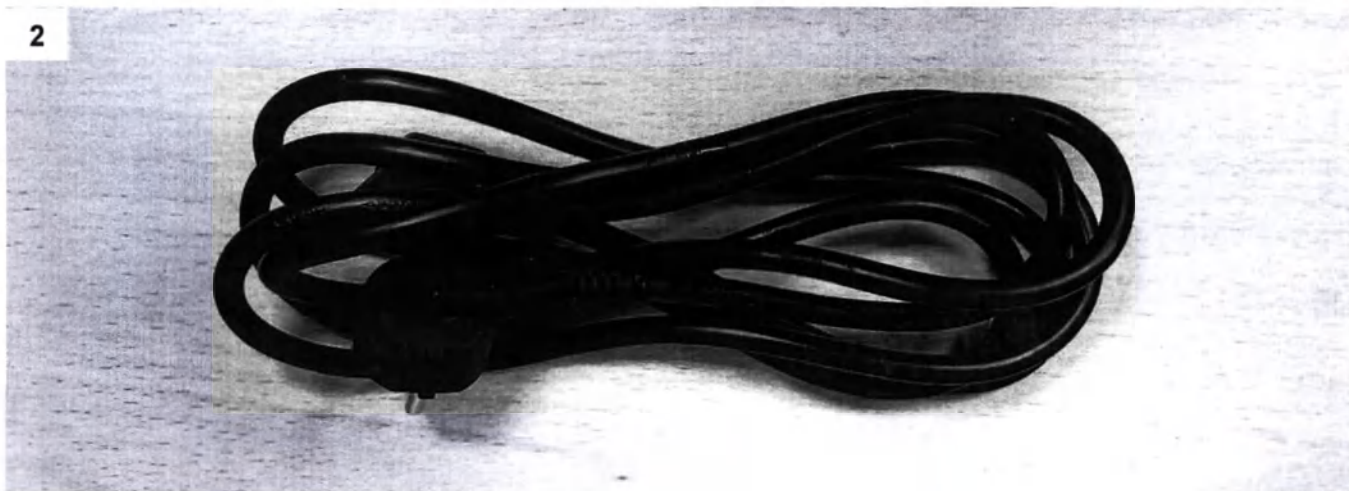


Фотографическое изображение аппарата электрохирургического высокочастотного ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 (генератор электрохирургический) – вид спереди и сверху (1) и кабеля питания (2).

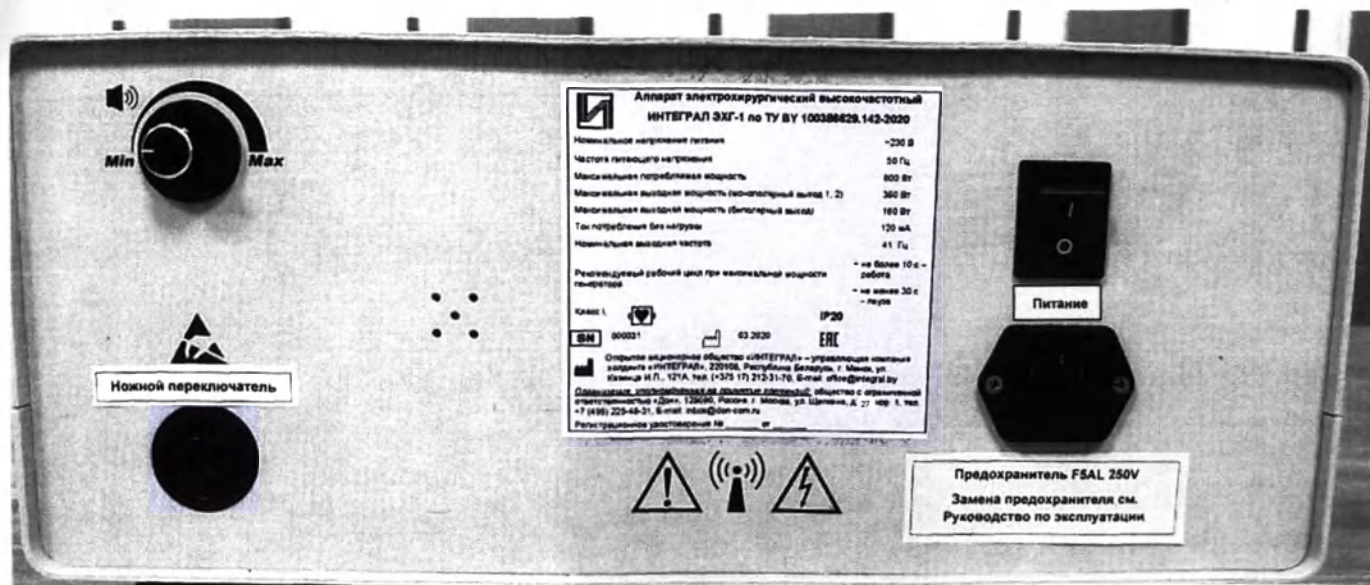

Фотографическое изображение аппарата электрохирургического высокочастотного ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 (генератор электрохирургический) – вид сзади.

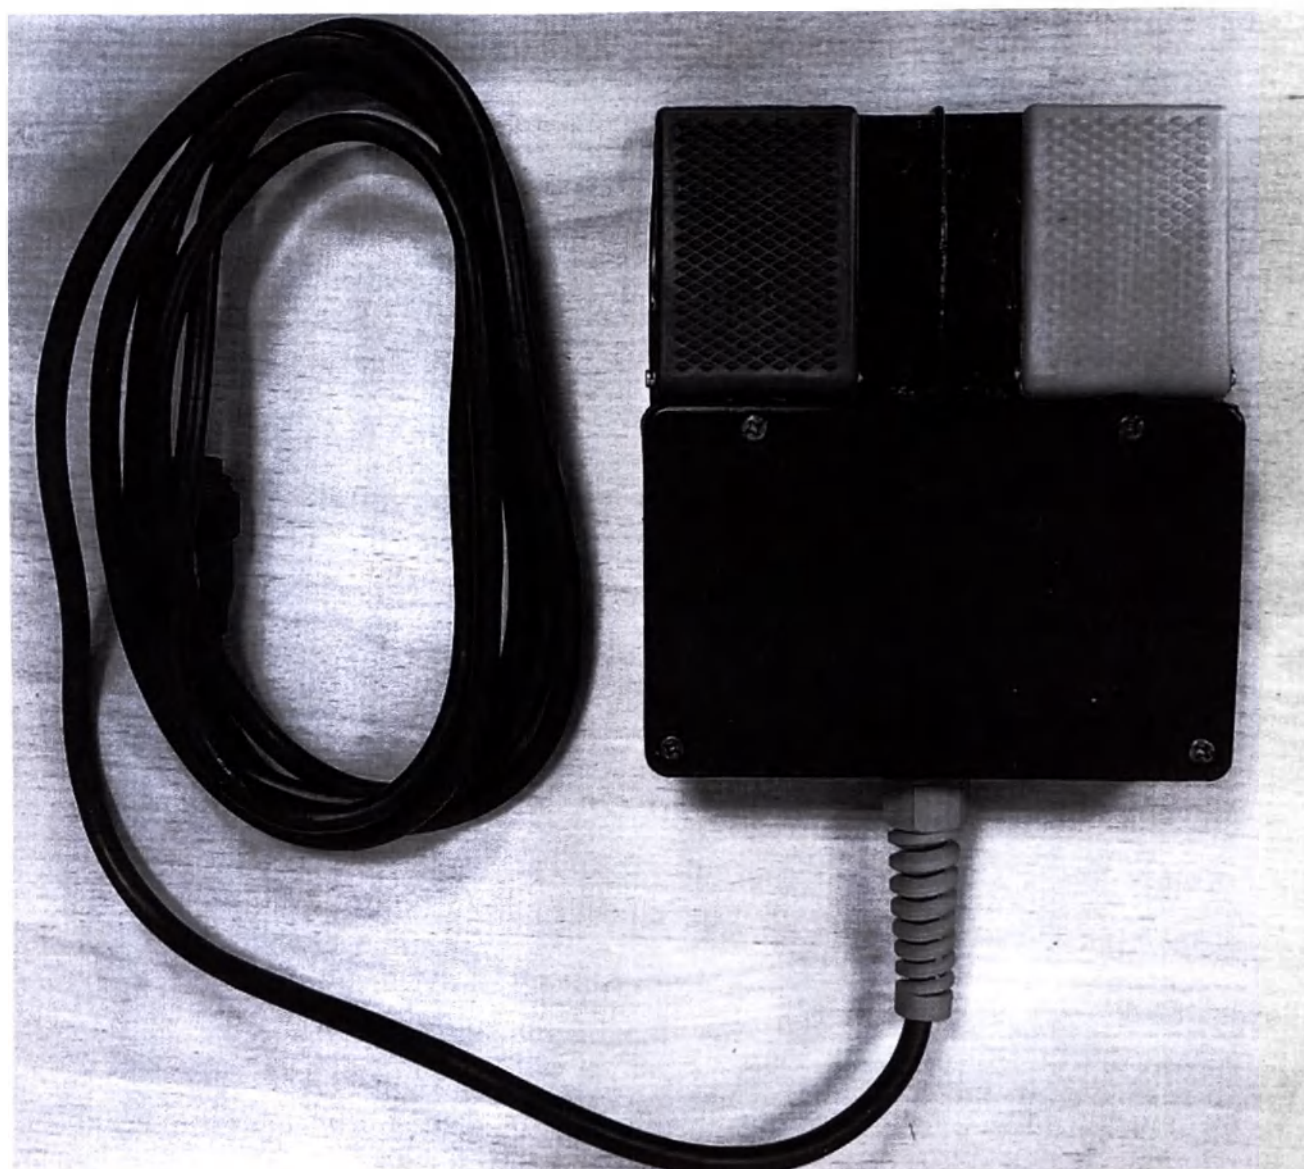

Фотографическое изображение переключателя ножного (педаль), вид сверху.

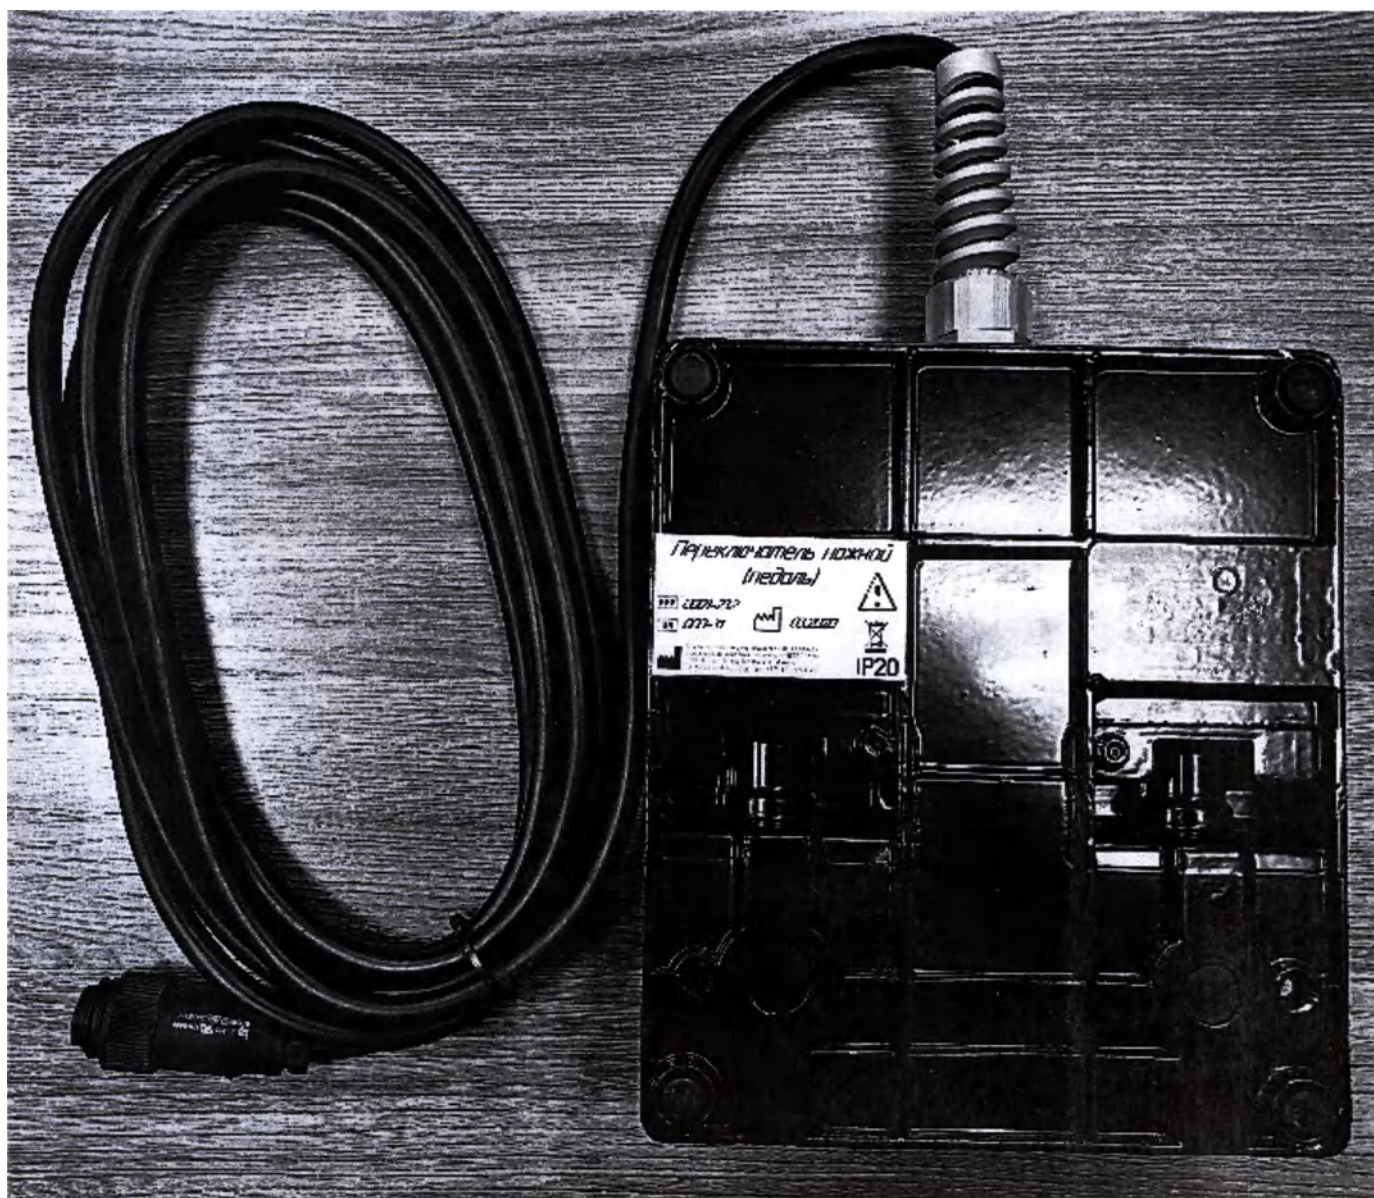

Фотографическое изображение переключателя ножного (педаль), вид снизу.

Министерство промышленности Республики Беларусь

Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» -
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Аппарат электрохирургический высокочастотный
ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 по ТУ ВУ 100386629.142-2020»

Датированная редакция: 07.10.2020

Гарантийный талон № 1
на ремонт генератора электрохирургического и переключателя
ножного «Аппарата электрохирургического высокочастотного
ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 по ТУ ВУ 100386629.142-2020»

И изготовитель: ул. Казинца И.П., 121А, к. 327, 220108, г. Минск,
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ», Республика Беларусь, тел. +375 17 21214 51, факс
+375 17 398 60 51, +375 17 398 44 71, +375 17 398 50 50 (Отдел
сервиса МТ и ИМН ЦЭТ Филиала НТЦ «Белмгоссистемы»).

Заводской № _____ Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____ (подпись или штамп торгующей организации)

Владелец и его адрес _____

Фамилия, подпись _____

Причина неисправности _____

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Руководитель ремонтного предприятия _____

Дата _____ Подпись _____

Печать ремонтного предприятия _____

Гарантийный талон № 2
на ремонт генератора электрохирургического и переключателя
ножного «Аппарата электрохирургического высокочастотного
ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 по ТУ ВУ 100386629.142-2020»

И изготовитель: ул. Казинца И.П., 121А, к. 327, 220108, г. Минск,
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ», Республика Беларусь, тел. +375 17 21214 51, факс
+375 17 398 60 51, +375 17 398 44 71, +375 17 398 50 50 (Отдел
сервиса МТ и ИМН ЦЭТ Филиала НТЦ «Белмгоссистемы»).

Заводской № _____ Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Продавец _____ (подпись или штамп торгующей организации)

Владелец и его адрес _____

Фамилия, подпись _____

Причина неисправности _____

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Руководитель ремонтного предприятия _____

Дата _____ Подпись _____

Печать ремонтного предприятия _____

Паспорт изделия

ФКСН.941611.001 П

Идентификация изделия

	Аппарат электрохирургический высокочастотный ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 по ТУ ВУ 100386629.142-2020
Серийный номер	000031
Дата выпуска	03.2020

Свидетельство о приеме

Изделие признано годным к эксплуатации

Дата приема _____

Примечание _____

Гарантия производителя

Гарантия производителя 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства вступают в силу с даты продажи изделия, подтвержденной штампом и подписью продавца в паспорте изделия. В период действия гарантийного срока производитель за свой счет обязуется осуществлять замену или ремонт неисправных частей изделия, если неисправности вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом или некачественной сборкой изделия.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации изделия.

В случае устранения неисправностей по гарантии, гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в следующих случаях:

- при нарушении потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации изделия;
- если дефект вызван форс-мажорными обстоятельствами, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- если ремонт изделия производился неуполномоченным сервисным центром или неквалифицированным персоналом;
- если изделие имеет повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети требованиям государственных стандартов;
- при обнаружении несанкционированных изменений конструкции или схемы изделия;
- если изделие имеет механические дефекты или повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостных веществ, жидкостей;
- если изделие имеет повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе, случаи нахождения грызунов и насекомых внутри устройства);

- В соответствии со статьей 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» и постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. № 55, изделие надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену на аналогичный товар (другого дизайна, модели, размера и др.).
- Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если ответственность производителя не установлена в законном порядке.
- Перед отправкой в сервисный центр необходимо:
 - произвести очистку изделия от механических и биологических загрязнений;
 - прикрепить сертификат обеззараживания (или другое письменное заявление о том, что очистка изделия выполнена) к внешней стороне упаковки;
 - упаковать изделие в оригинальную упаковку.
- Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить изделие и заполненный паспорт.

Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), гарантийного талона (2), паспорта (3) аппарата электрохирургического высокочастотного ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1.

Упаковочный лист

Аппарат электрохирургический высокочастотный
ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1 по ТУ ВУ 100386629.142-2020


№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Генератор электрохирургический	1	
2	Переключатель ножной	1	
3	Кабель питания от сети 220 В	1	
4	Руководство по эксплуатации	1	
5	Паспорт	1	
6	Гарантийный талон	1	
7	Упаковочный лист	1	
8	Кабель для нейтральных электродов многократного пользования	1	
9	Нейтральный электрод многократного пользования для взрослых	1	
10	Держатель монополярный с кабелем	1	
11	Электрод-нож короткий прямой без изолированного стержня антипригарный	1	
12	Электрод-игла короткий прямой без изолированного стержня антипригарный	1	
13	Электрод-шарик короткий прямой без изолированного стержня антипригарный	1	
14	Кабель биполярный	1	
15	Пинцет биполярный прямой, бранши прямые, неантипригарный	1	

Упаковщик _____ (Ф.И.О.)

Дата _____

Фотографическое изображение упаковочного листа аппарата электрохирургического
высокочастотного ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1.


1

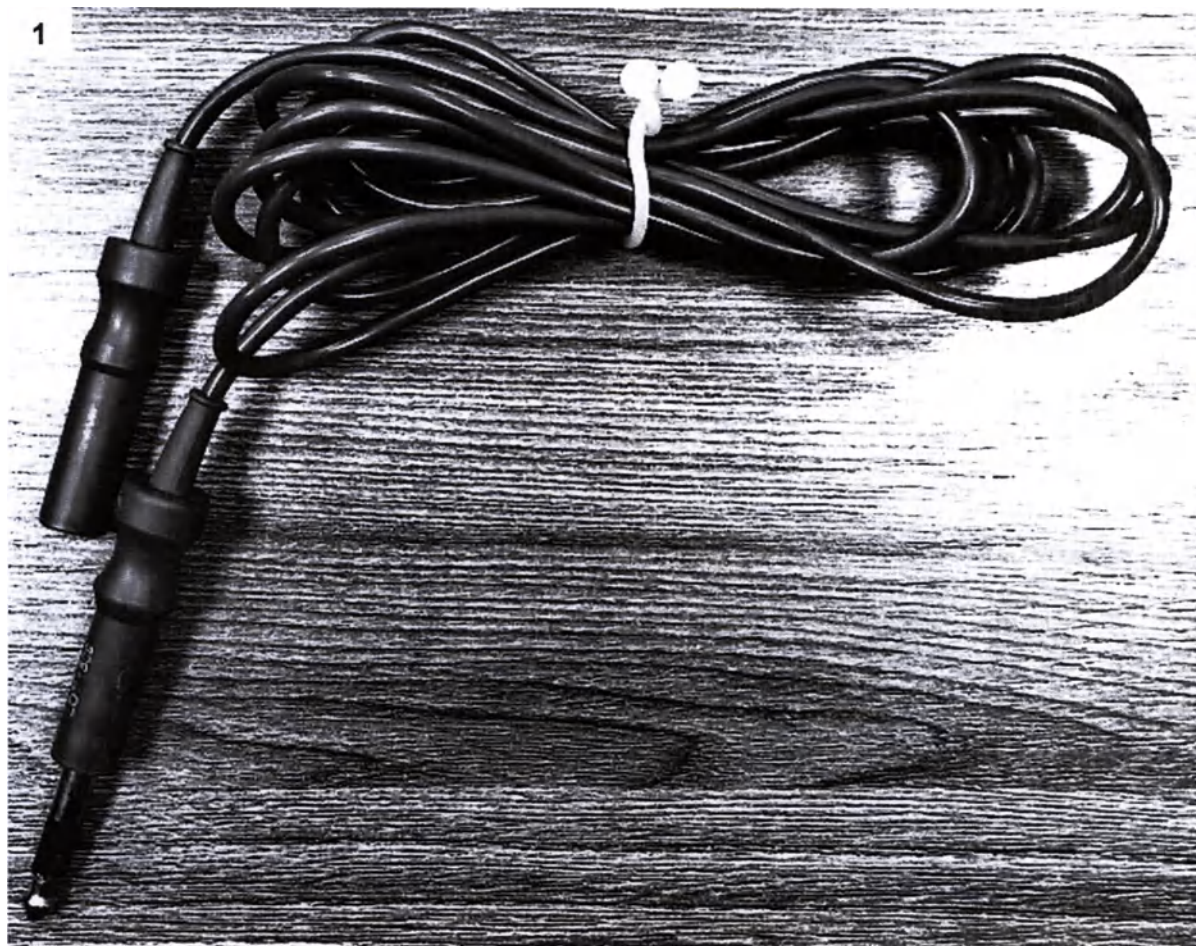

2




Фотографическое изображение кабеля для нейтральных электродов многоразового пользования без упаковки (1) и в упаковке (2).

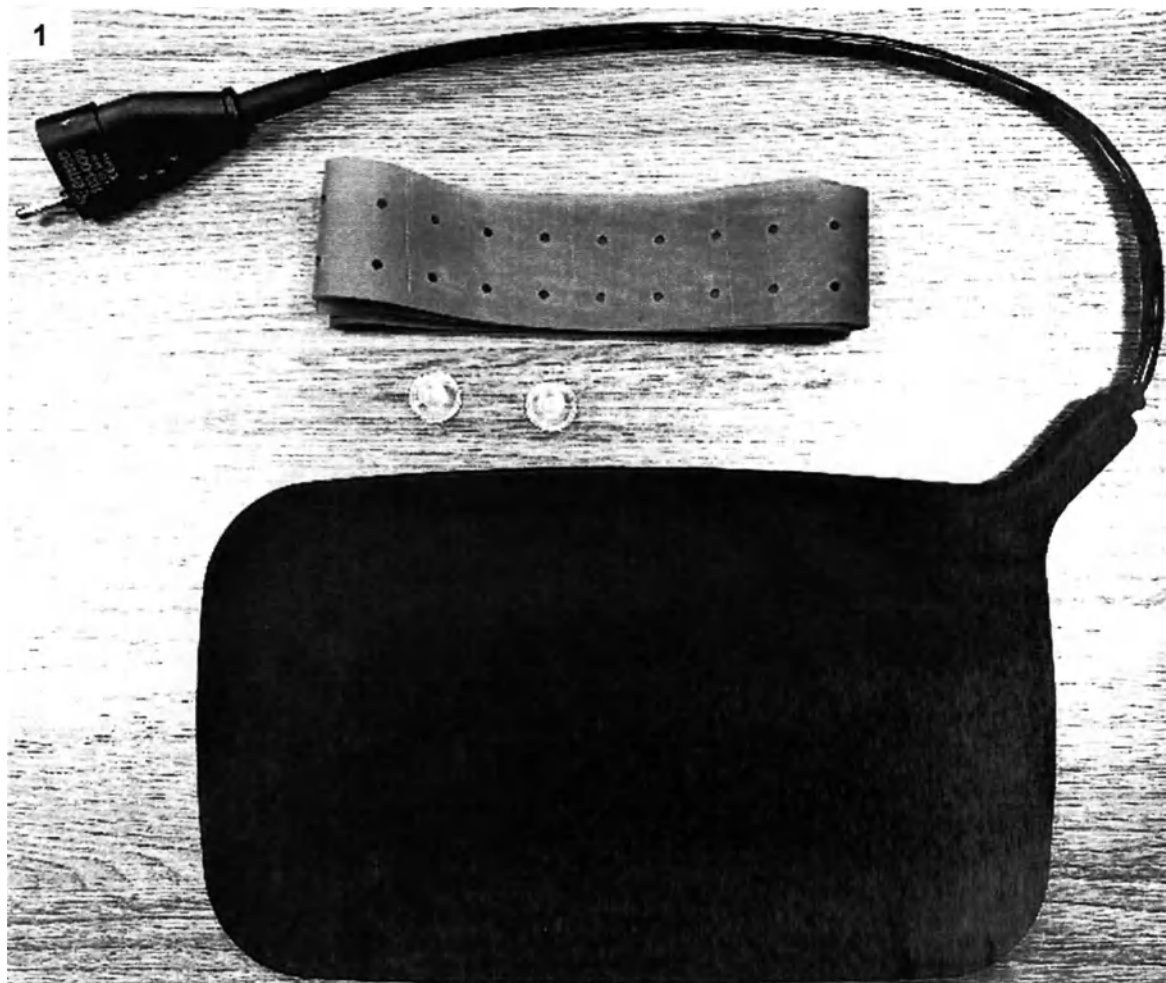

Фотографическое изображение нейтрального электрода многократного пользования для взрослых, с резиновым ремнем, с фиксатором; без упаковки (1) и в упаковке (2).



Фотографическое изображение держателя монополярного с кабелем [HD-01-02R] без упаковки (1)
и в упаковке (2).

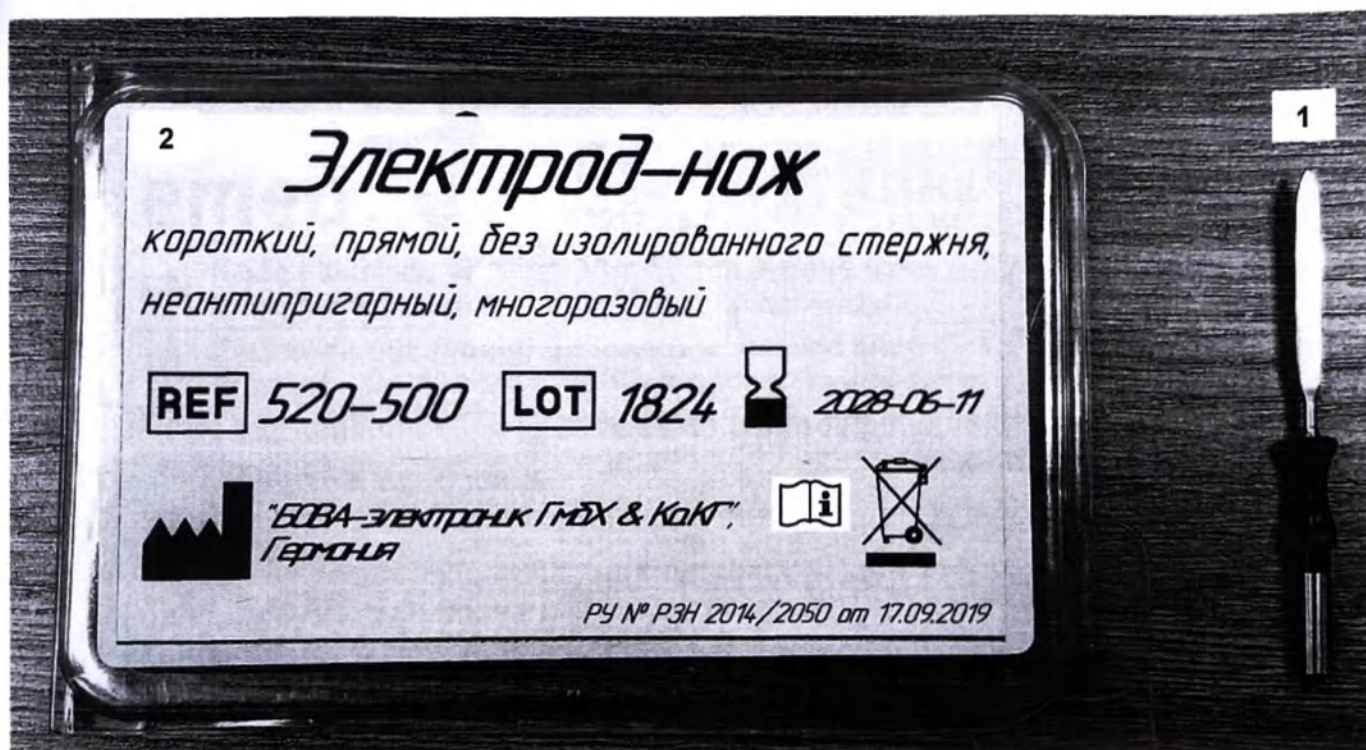


Фотографическое изображение электрода-ножа короткого; прямого; без изолированного стержня; неантипригарного, многоразового; без упаковки (1) и в упаковке (2).




Фотографическое изображение электрода-шарика короткого; прямого; без изолированного стержня; неантипригарного, многоразового; без упаковки (1) и в упаковке (2).



Фотографическое изображение электрода-иглы короткого; прямого; без изолированного стержня; неантипригарного, многоразового; без упаковки (1) и в упаковке (2).

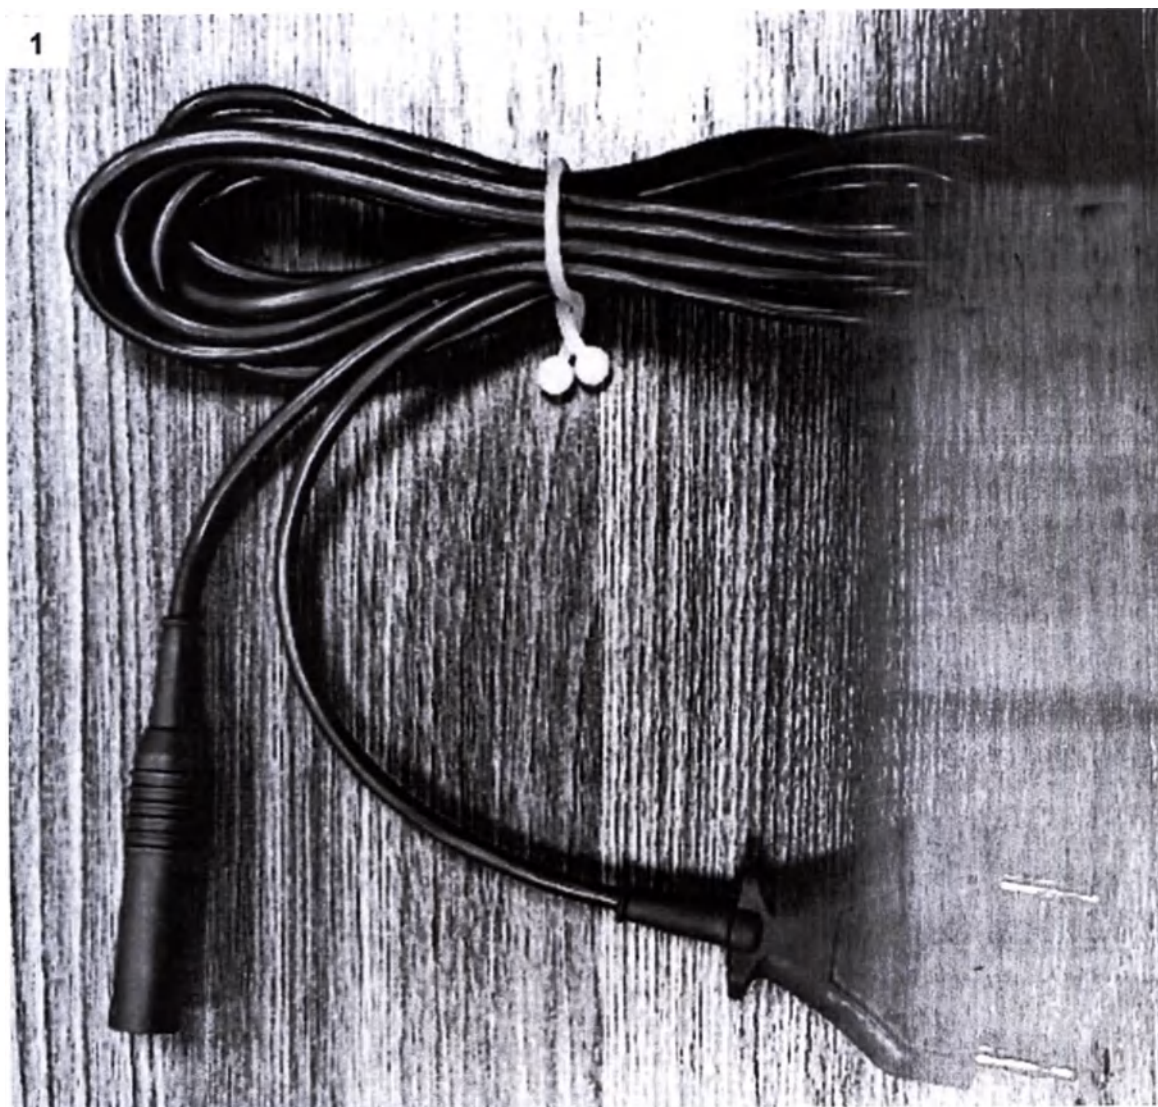


Фотографическое изображение кабеля биполярного без упаковки (1) и в упаковке (2).

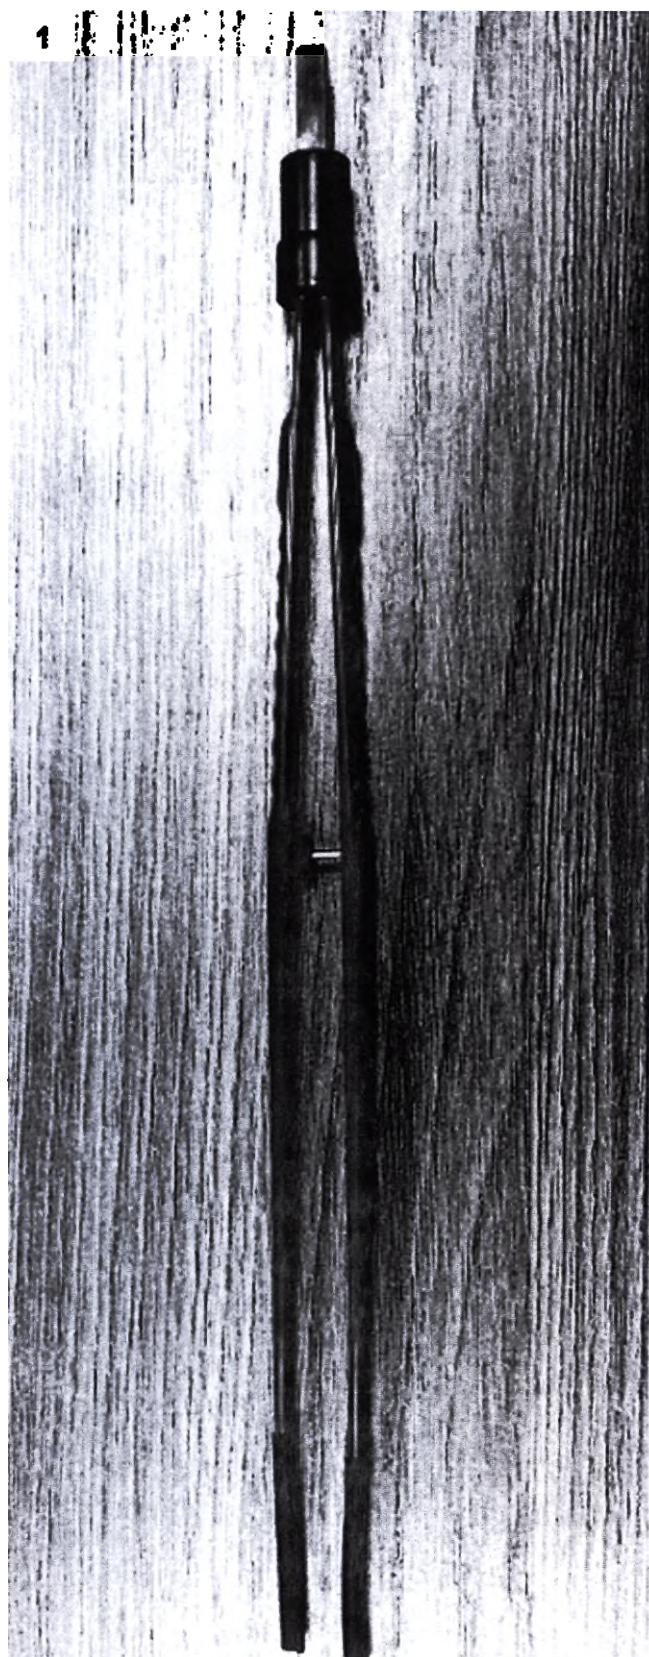


Фотографическое изображение пинцета биполярного, прямого, бранши: прямые, неантипригарного; без упаковки (1) и в упаковке (2).


1

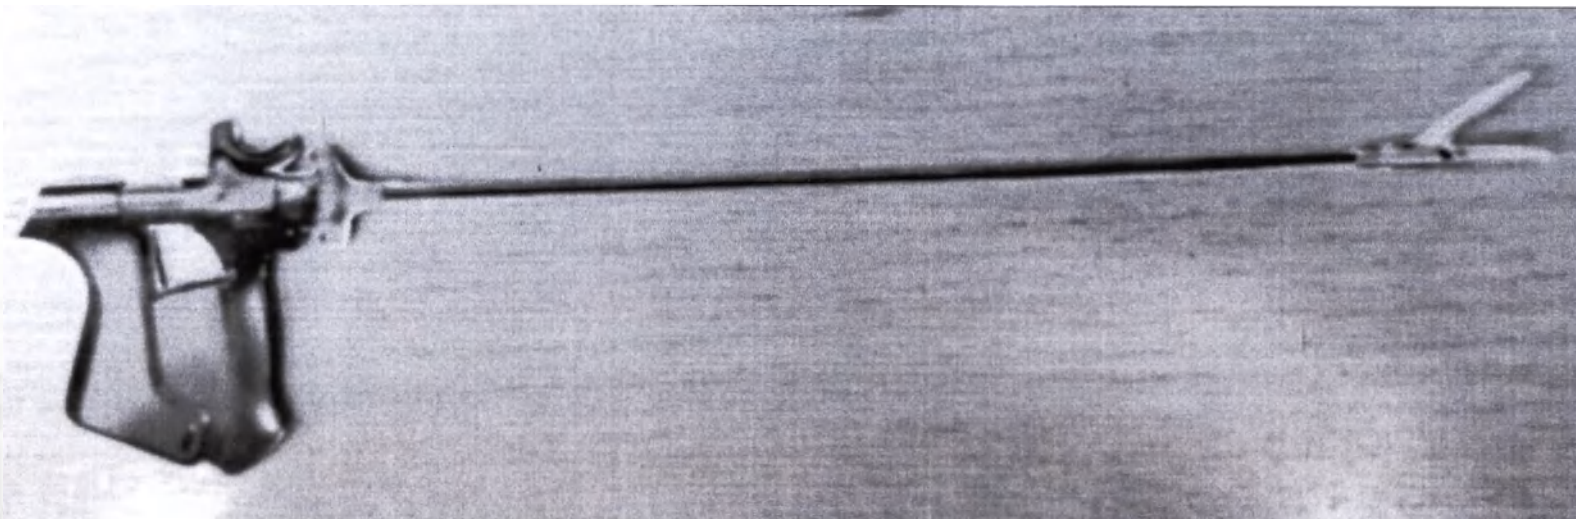



2

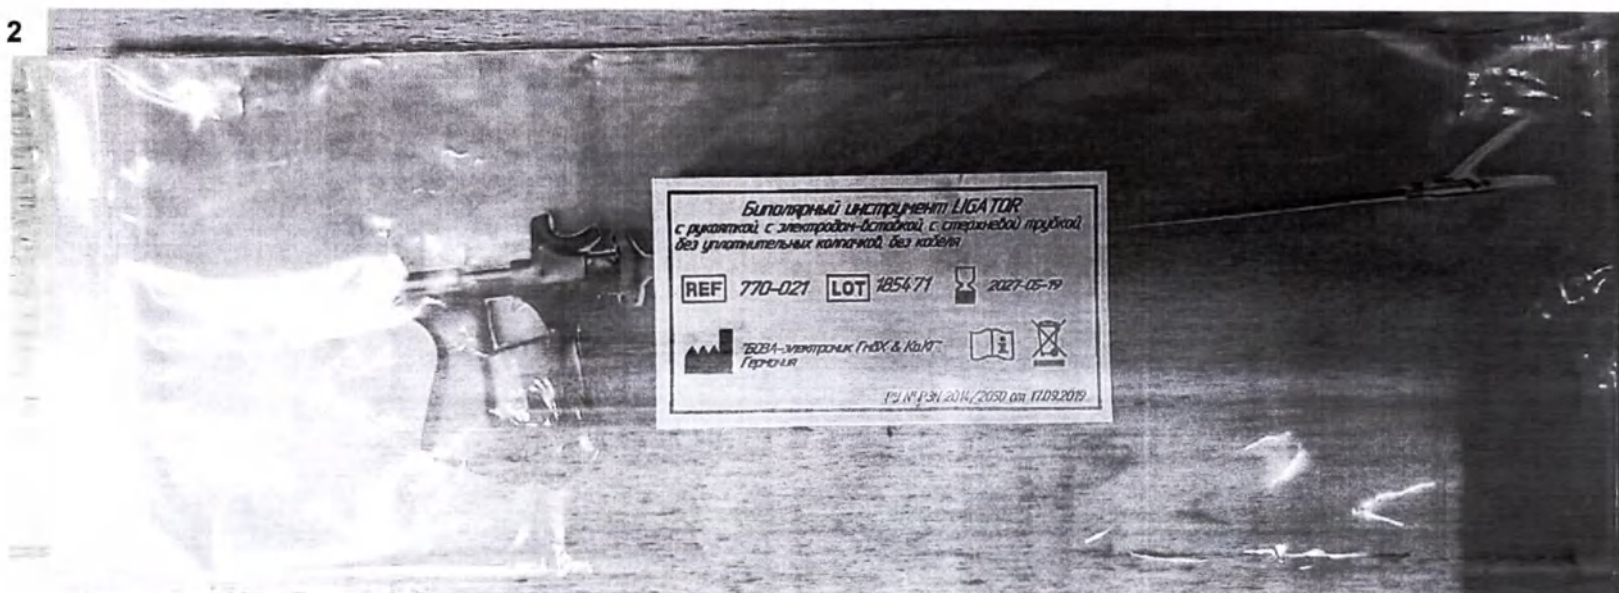

Фотографическое изображение биполярного инструмента LIGATOR с рукояткой, с электродом-вставкой, со стержневой трубкой, без уплотнительных колпачков, без кабеля; без упаковки (1) и в упаковке (2)

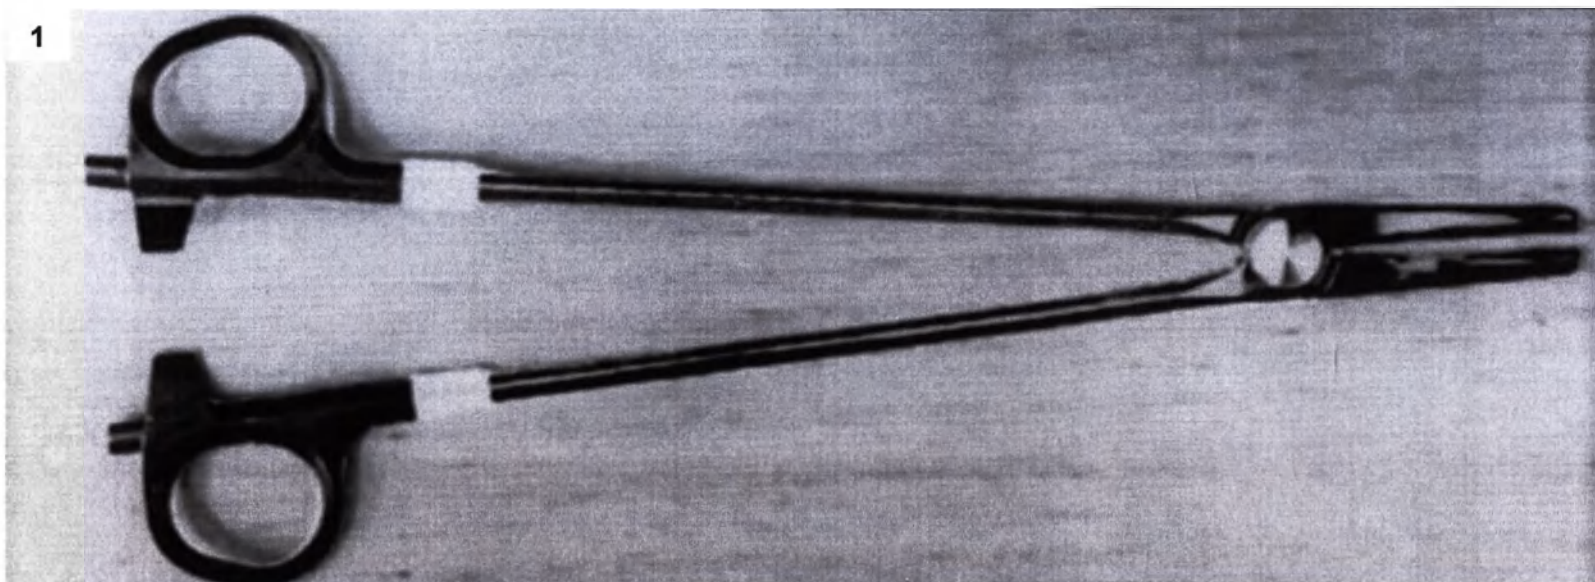

Фотографическое изображение биполярного инструмента TissueSeal без кабеля; без упаковки (1) и в упаковке (2).

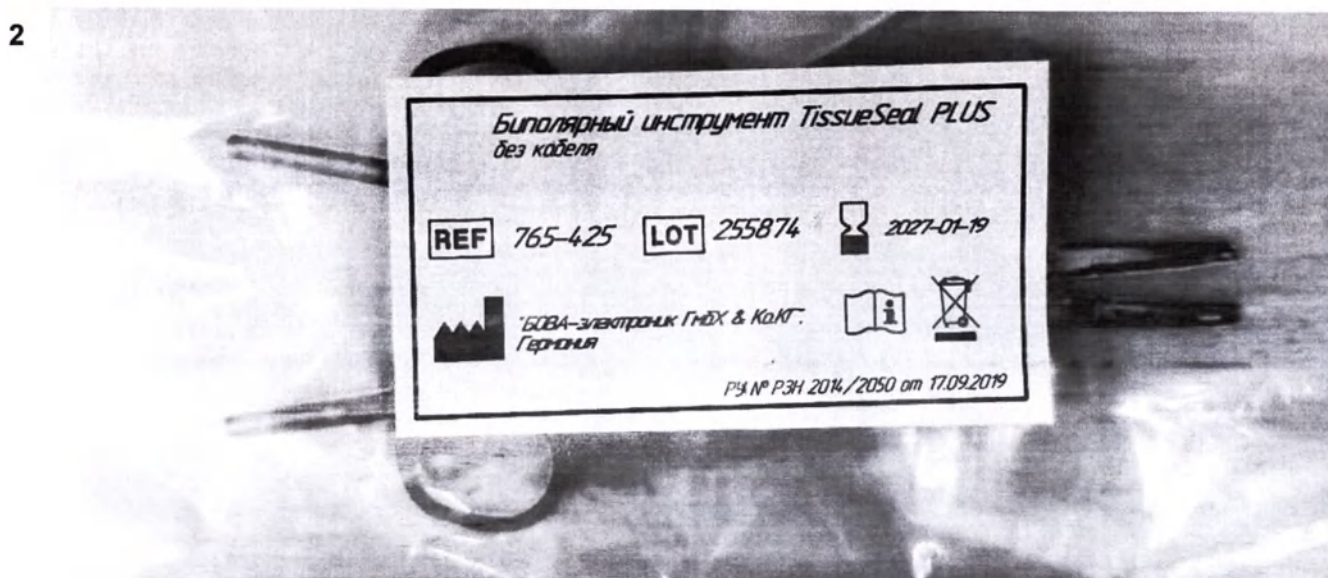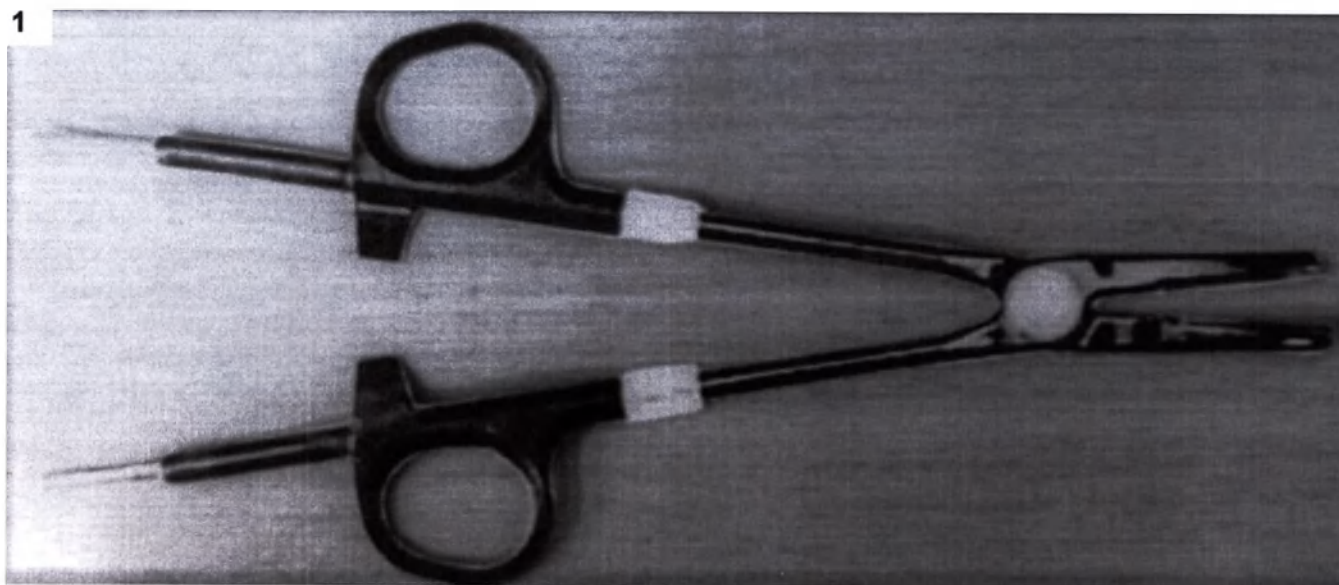

Фотографическое изображение биполярного инструмента TissueSeal PLUS без кабеля; без упаковки (1) и в упаковке (2).



Фотографическое изображение транспортной упаковки аппарата электрохирургического высокочастотного ИНТЕГРАЛ ЭХГ-1.

Прошито и пронумеровано

17 (синадцать)

лист(а)(ов)



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

С.Д. Бабанский