


Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз



Денисенко Е.А.

2024 г.

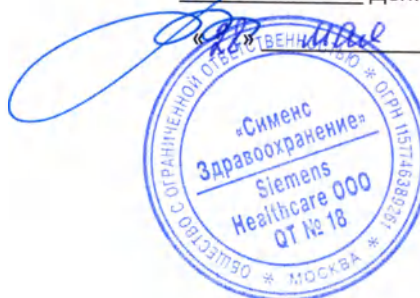

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»):

- I. Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D)
- II. Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC)
- III. Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) в вариантах исполнения



Рисунок 1 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 100 тестов) (общий вид фото 1)

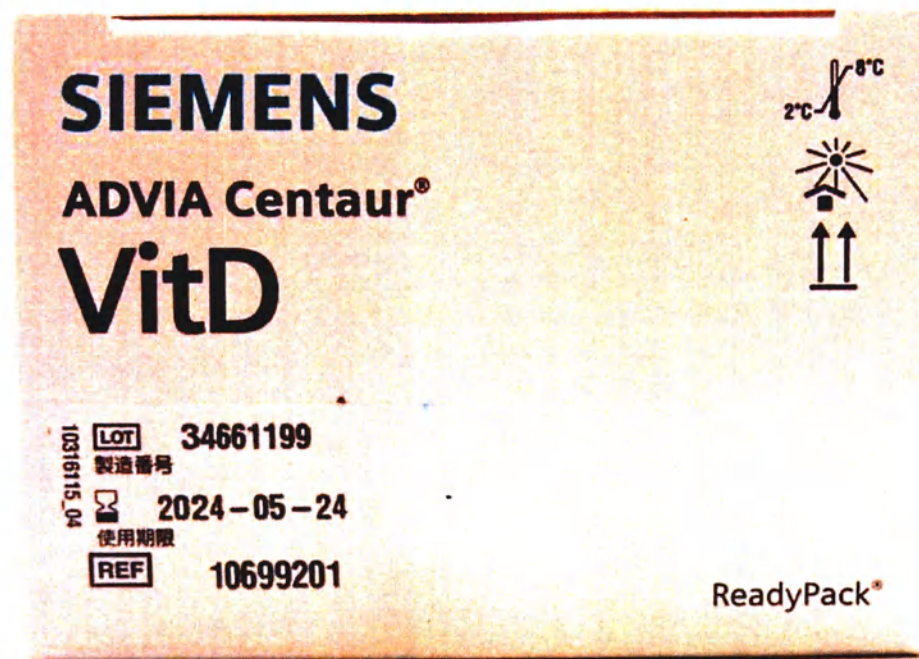


Рисунок 2 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 100 тестов) (общий вид фото 2)

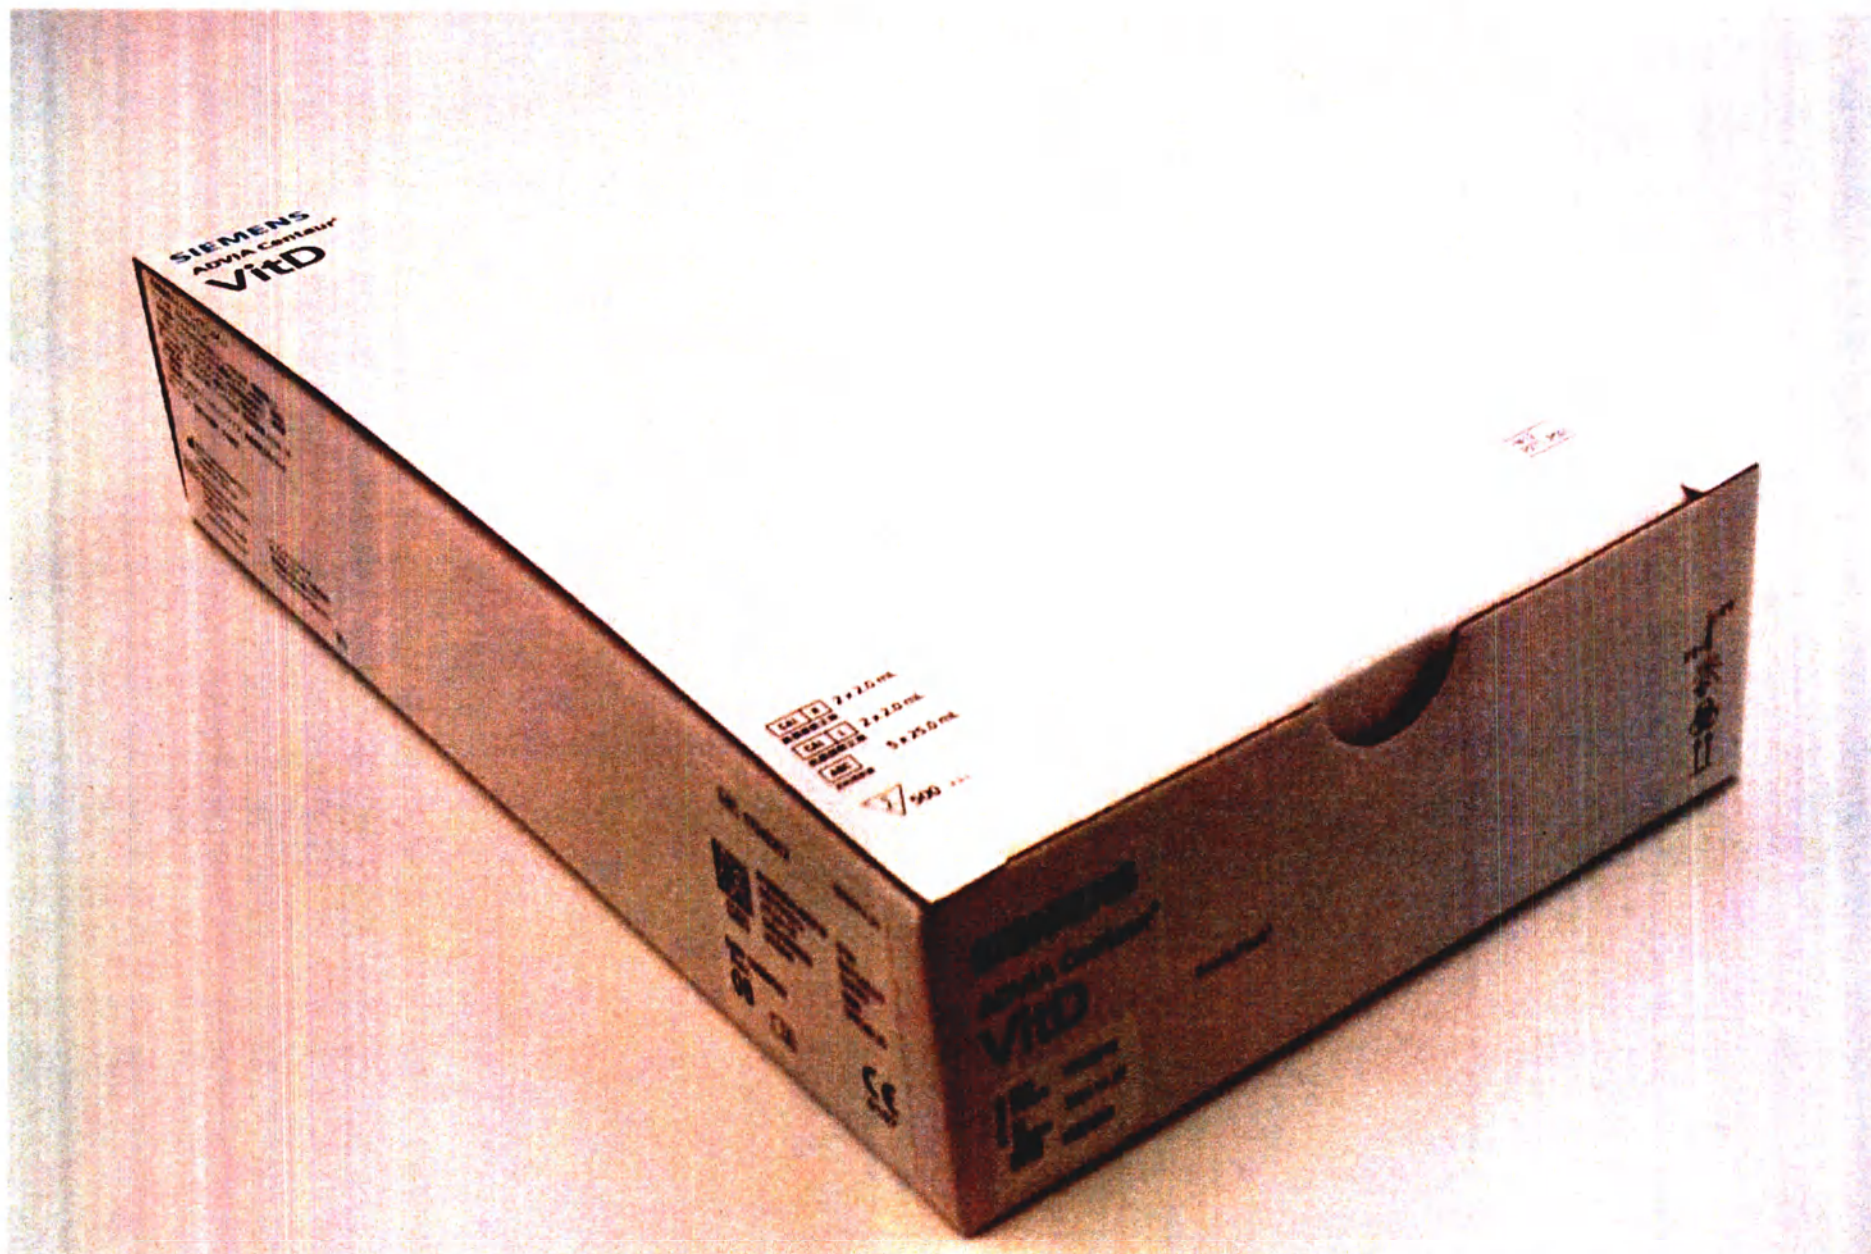


Рисунок 3 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 1)

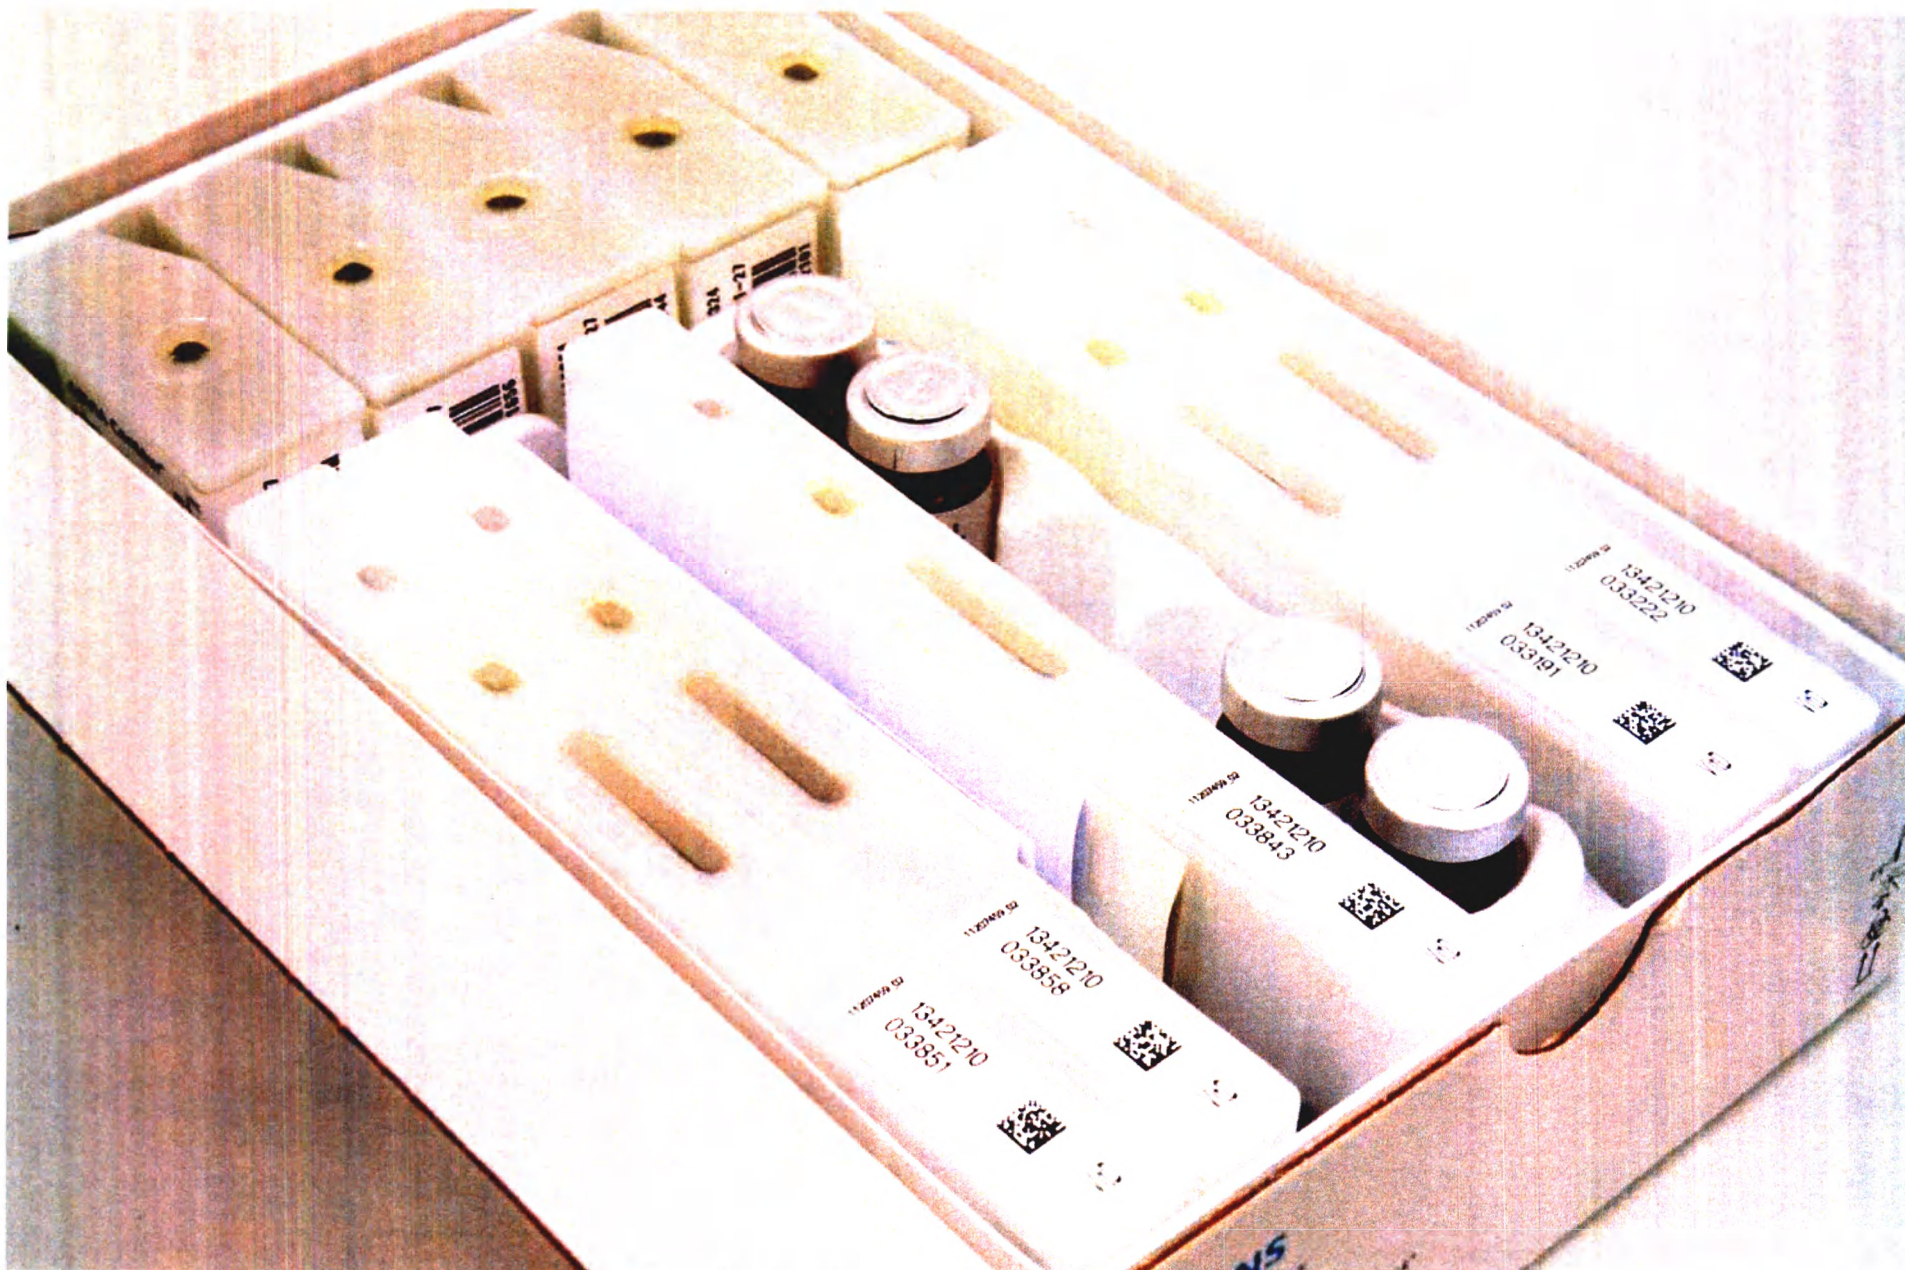


Рисунок 4 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 2)

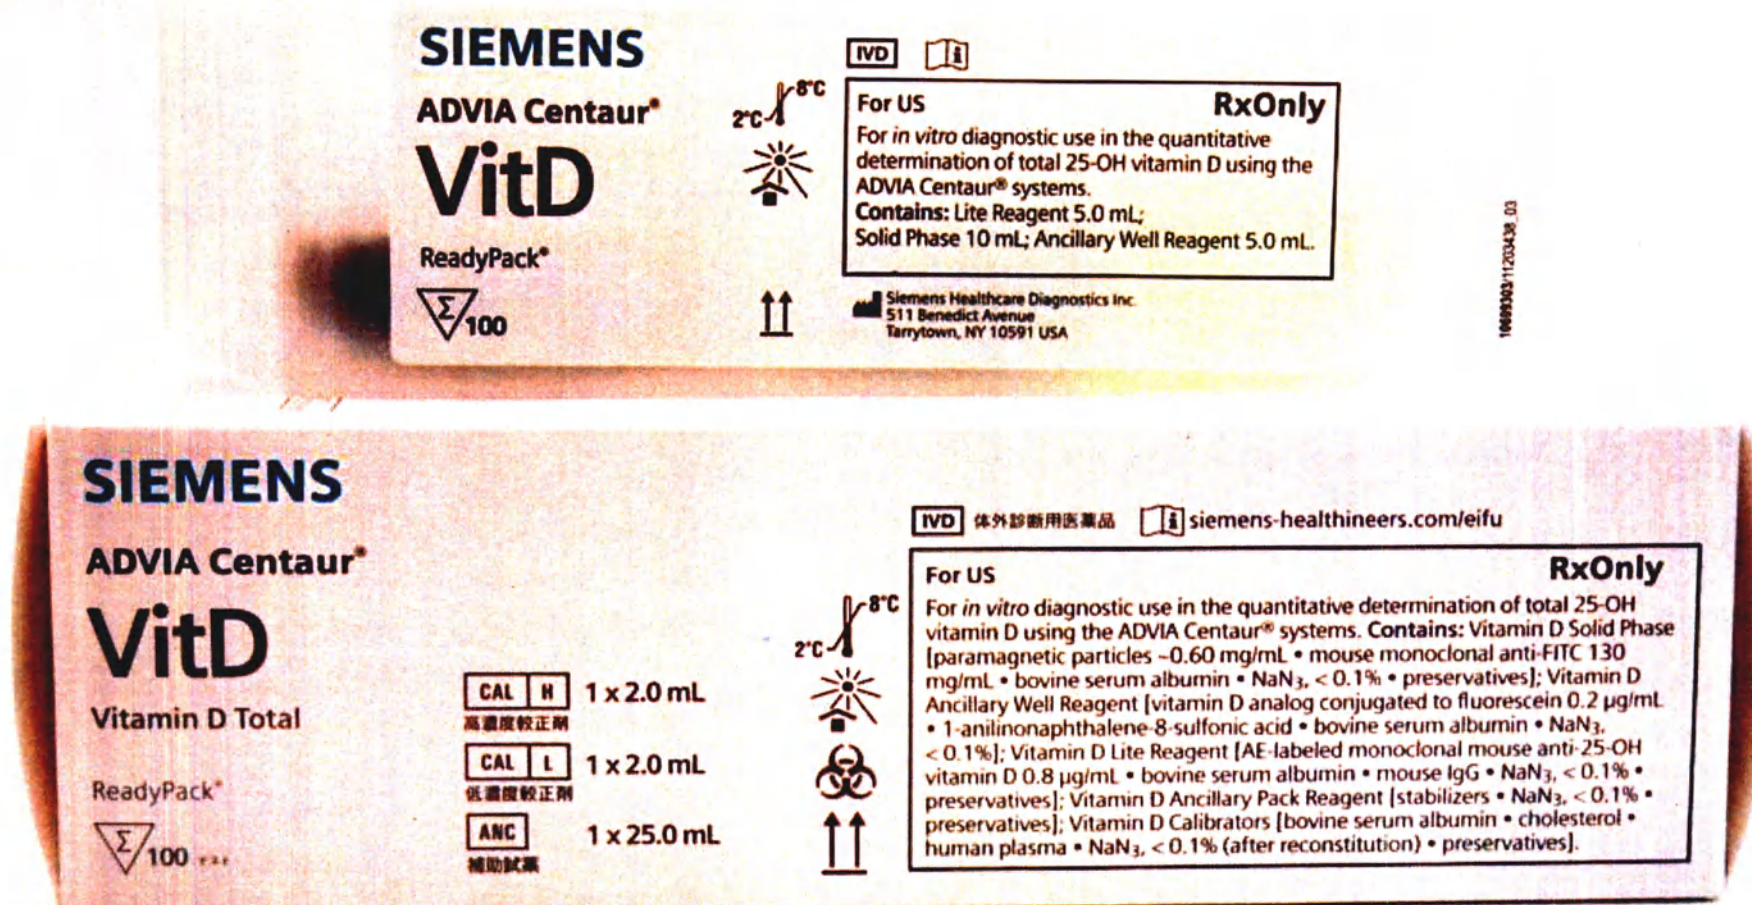


Рисунок 5 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D): - реагент первичный ReadyPack содержащий реагенты Lite Reagent для анализа на ADVIA Centaur VitD, Solid Phase и Ancillary Well Reagent

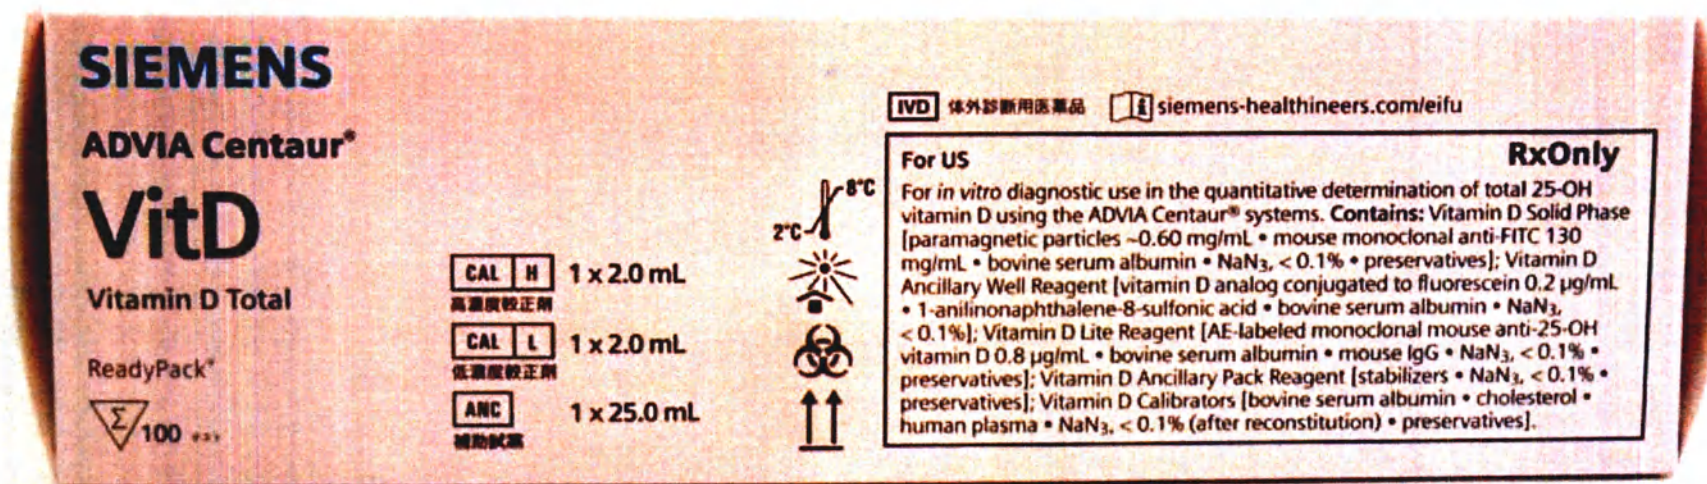
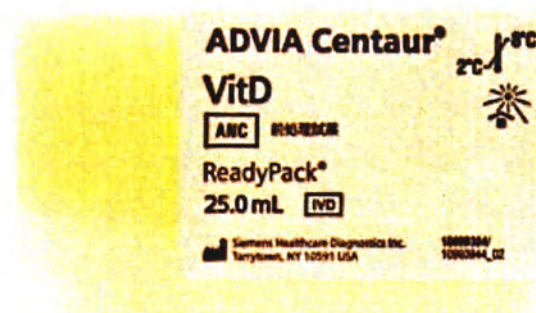


Рисунок 6 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D): - реагент дополнительный ReadyPack, содержащий Ancillary Reagent для анализа на ADVIA Centaur VitD;

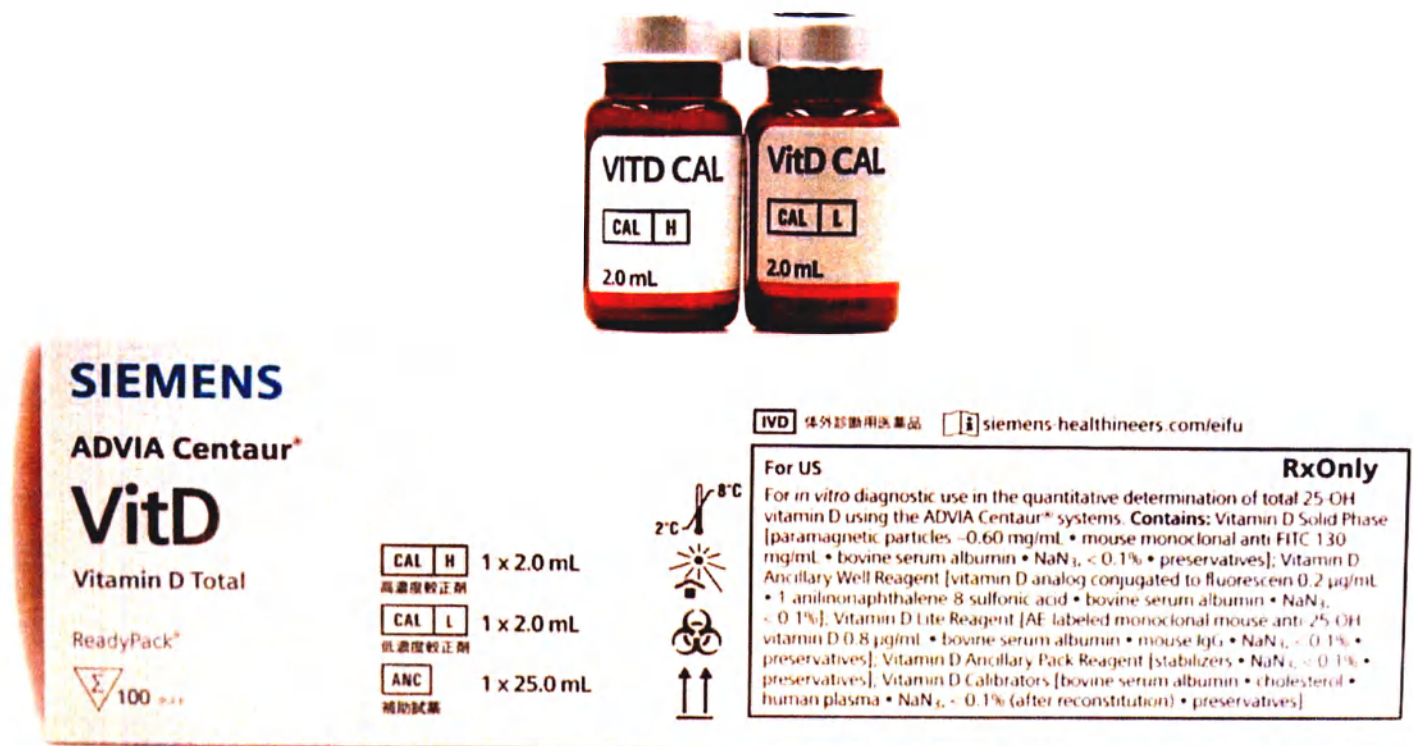


Рисунок 7 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D):

- калибратор (высокий уровень) для анализа на ADVIA Centaur VitD
- калибратор (низкий уровень) для анализа на ADVIA Centaur VitD



Рисунок 8 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D): - карта эталонной кривой для анализа на ADVIA Centaur VitD в системах;

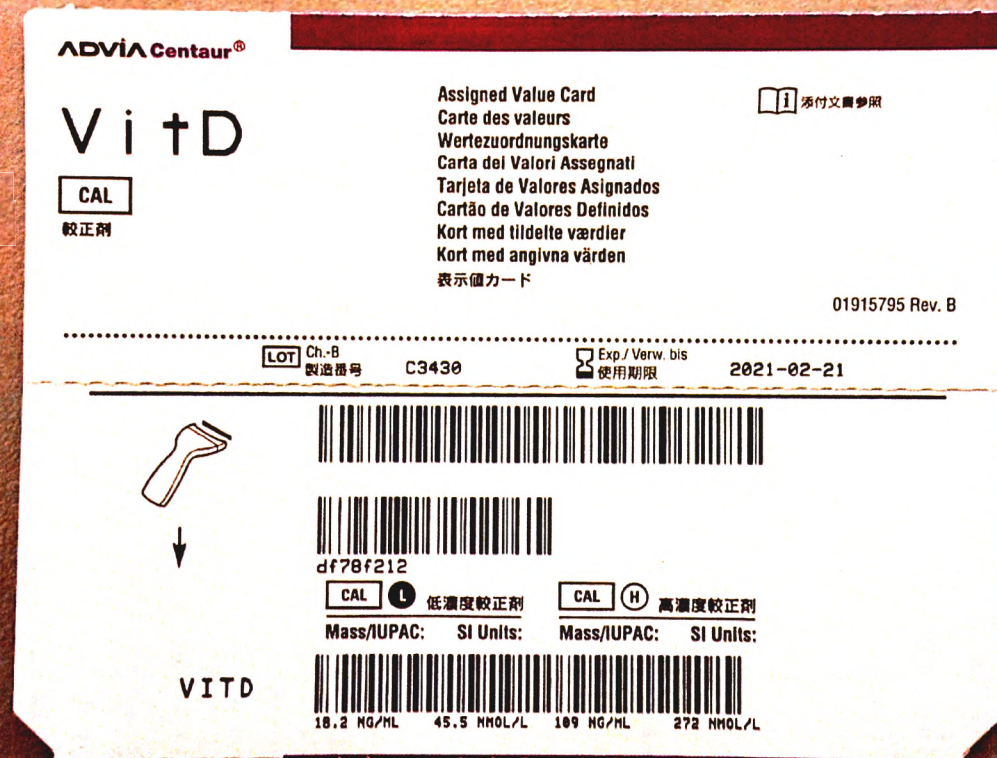


Рисунок 9 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D): - карта целевых значений для калибраторов для анализа на ADVIA Centaur VitD в системах

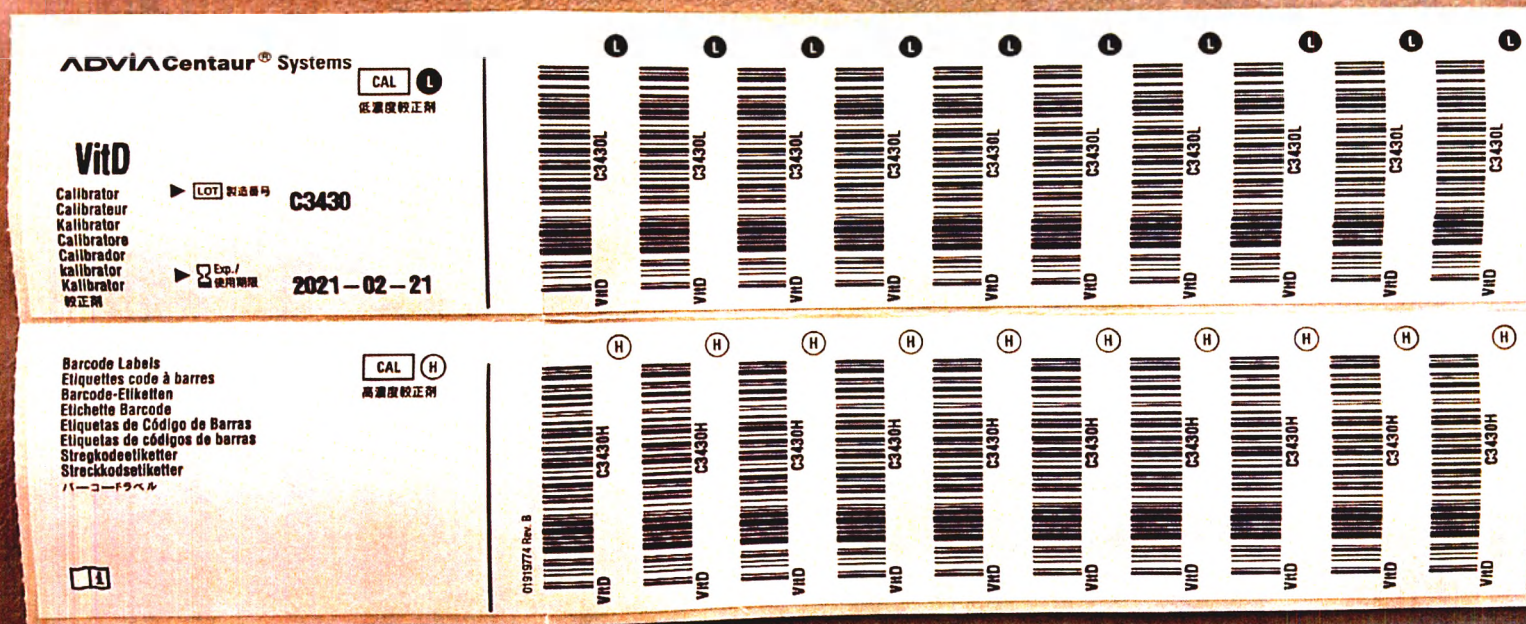


Рисунок 10 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D): - этикетки со штрих-кодами.

10699201 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 100 тестов)

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/6107 от 15.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 100 тестов) : макет русскоязычной маркировки

10699533 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 500 тестов)

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/6107 от 15.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 12 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D) (Фасовка 500 тестов) : макет русскоязычной маркировки



Рисунок 13 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC) (общий вид)



Рисунок 14 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Контрольный материал для определения общего витамина Д, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC) (общий вид фото 2)



Рисунок 15 Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC): - лиофилизированный контрольный материал, уровень 1 (Control 1)



Рисунок 16 Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC) - лиофилизированный контрольный материал, уровень 2 (Control 2)

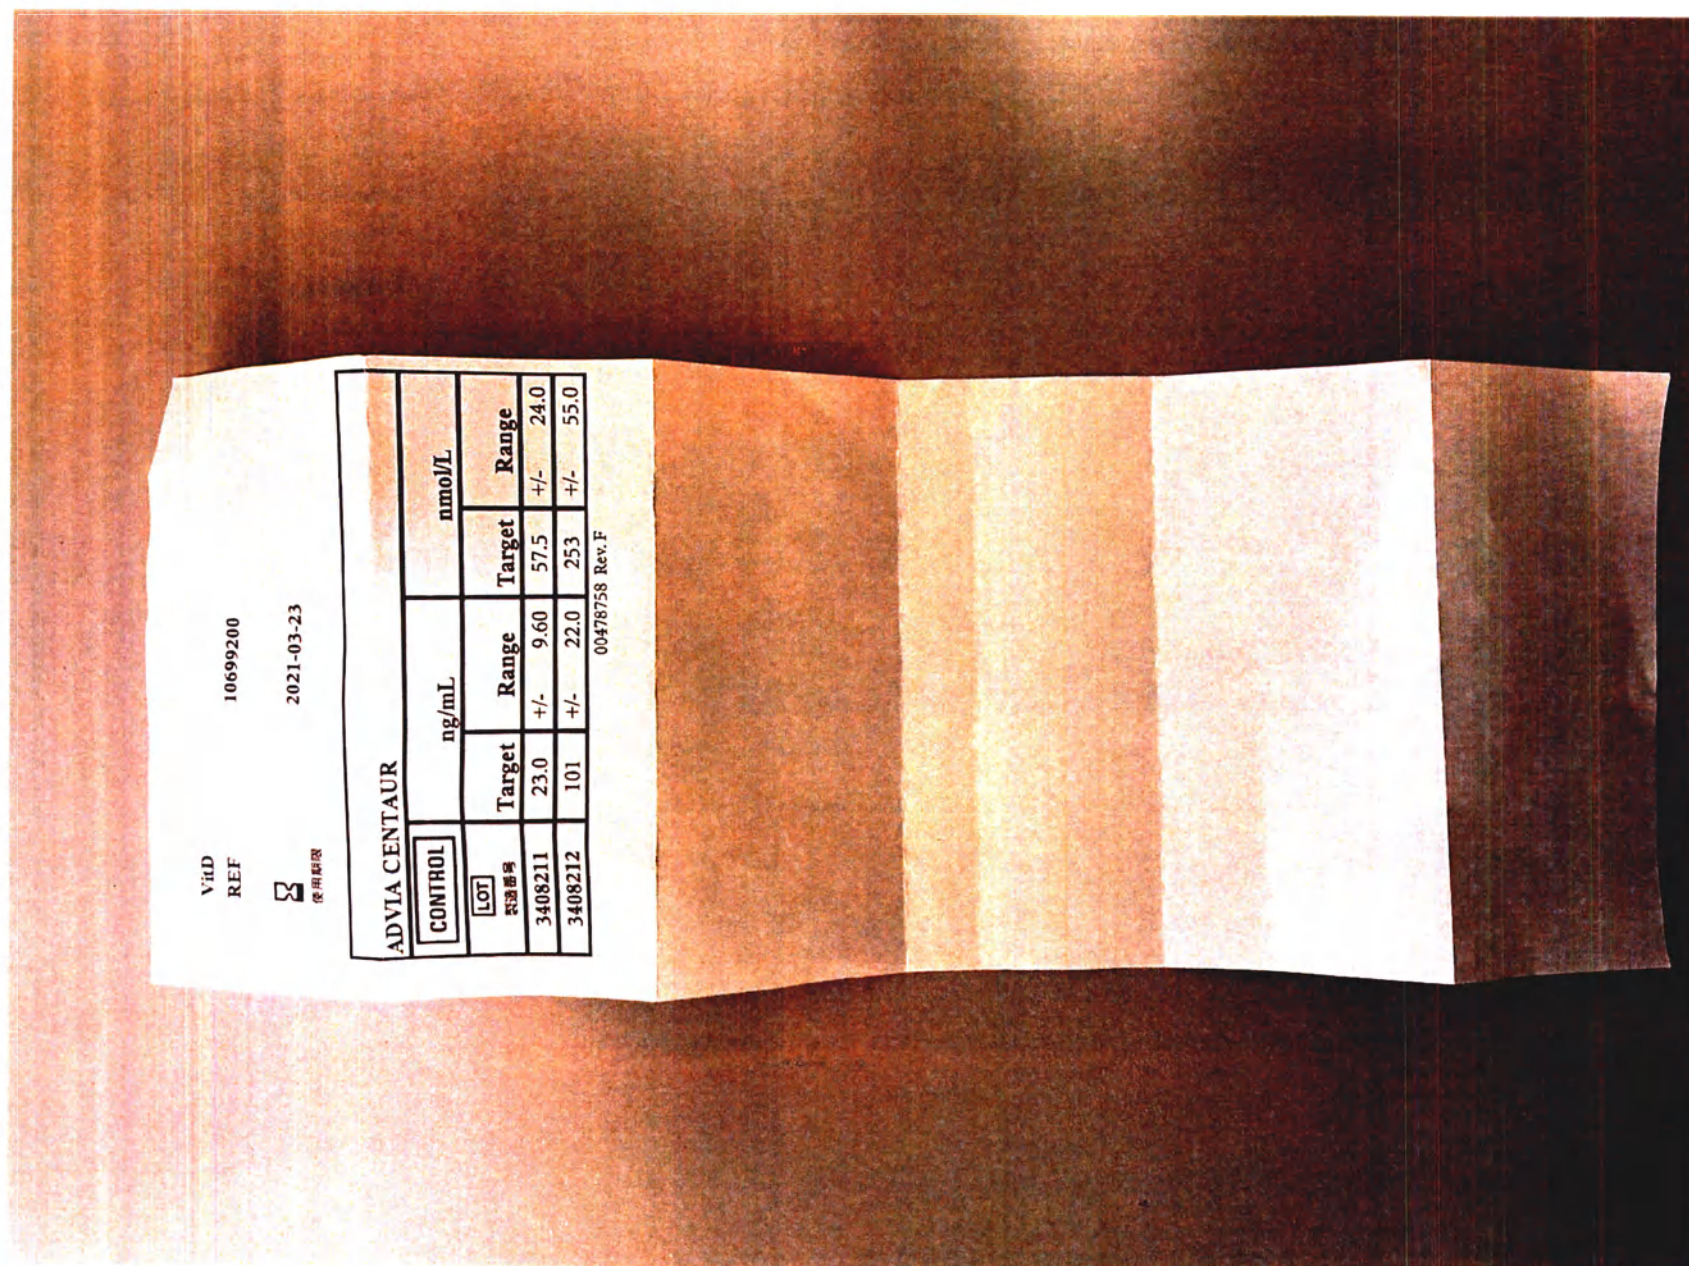


Рисунок 17 Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC): - карта ожидаемых значений;

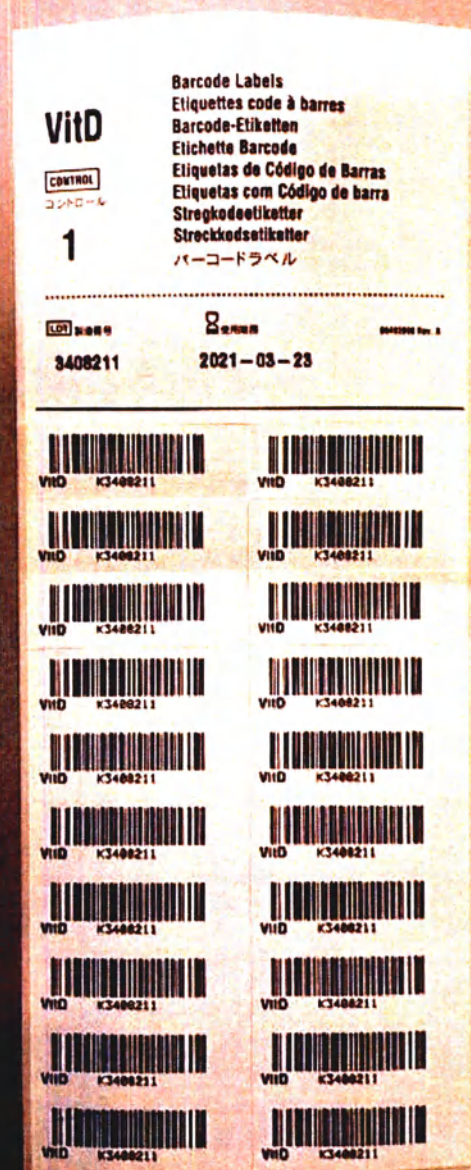


Рисунок 18 Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC): - этикетки со штрих-кодами.

10699200 Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC)

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/6107 от 15.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 19 Контрольный материал для определения общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Control (Vit D QC): макет русскоязычной маркировки



Рисунок 20 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) (общий вид упаковки)



Рисунок 21 Дилуэнт для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) (общий вид упаковки сбоку 1)

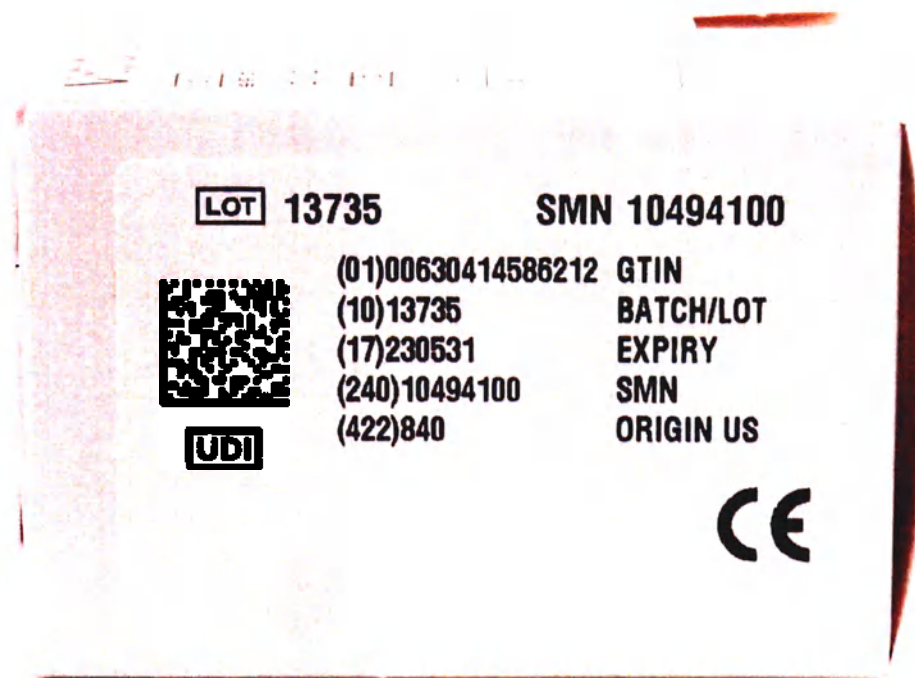


Рисунок 22 Дилуэнт для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) (общий вид упаковки сбоку 2)

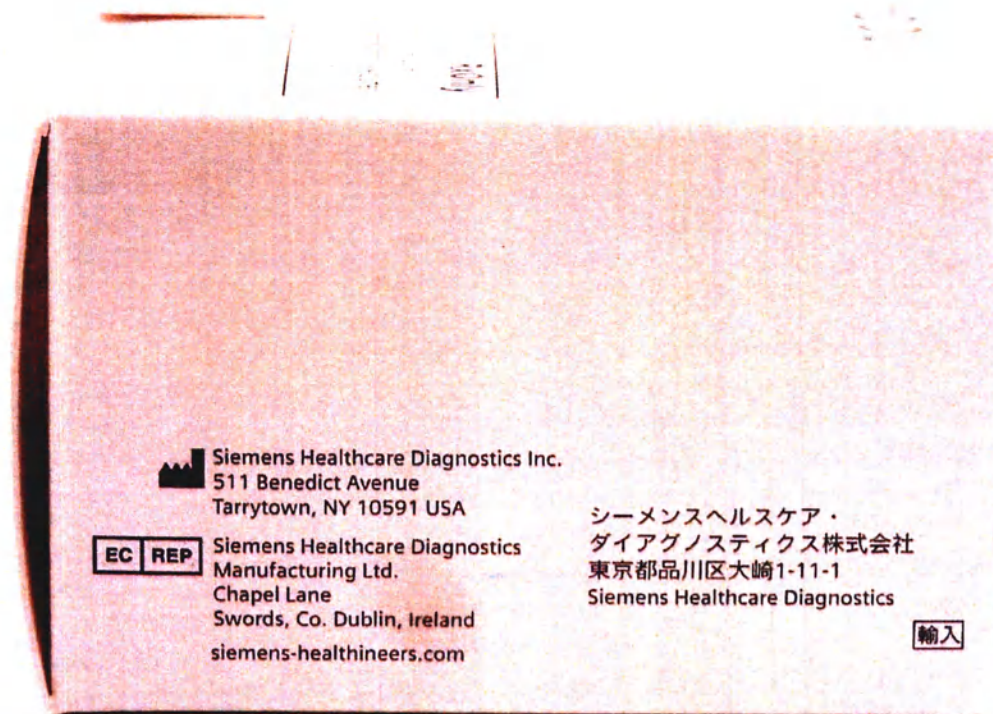


Рисунок 23 Дилуэнт для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) (общий вид упаковки сбоку 3)



Рисунок 24 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) (общий вид упаковки сверху)

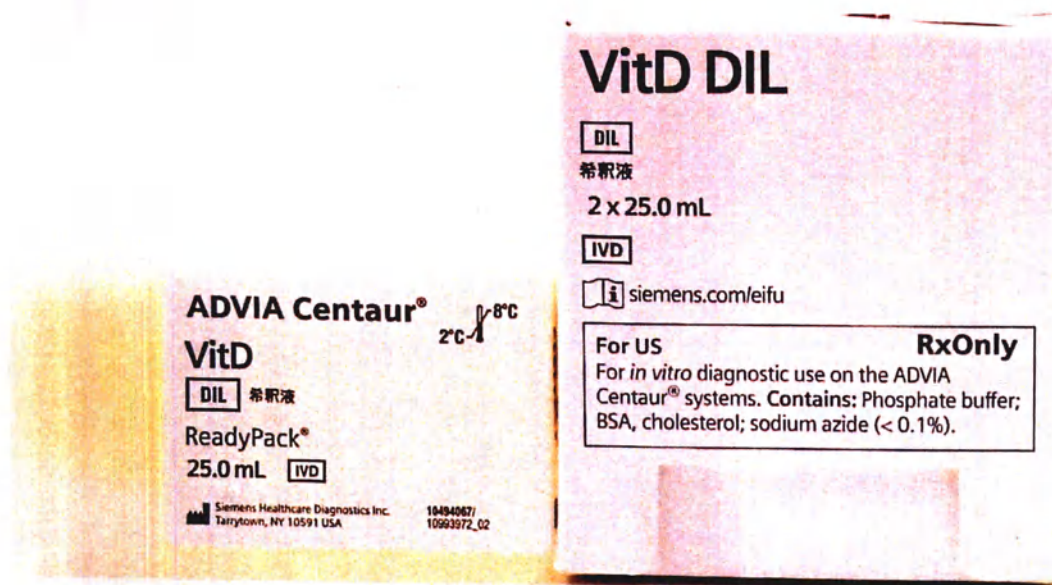


Рисунок 25 Дилуэнт для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) - флаконы

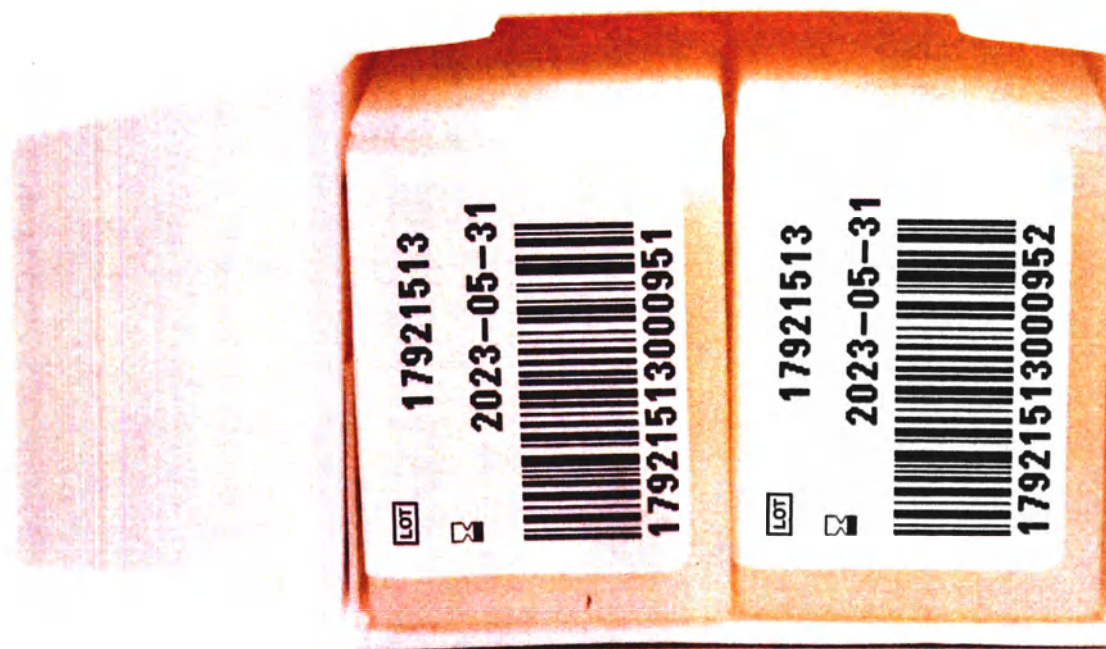


Рисунок 26 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.) – открытая упаковка

10494100

Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.)

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/6107 от 15.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 27 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон, 2 фл./1 уп.): макет русскоязычной маркировки

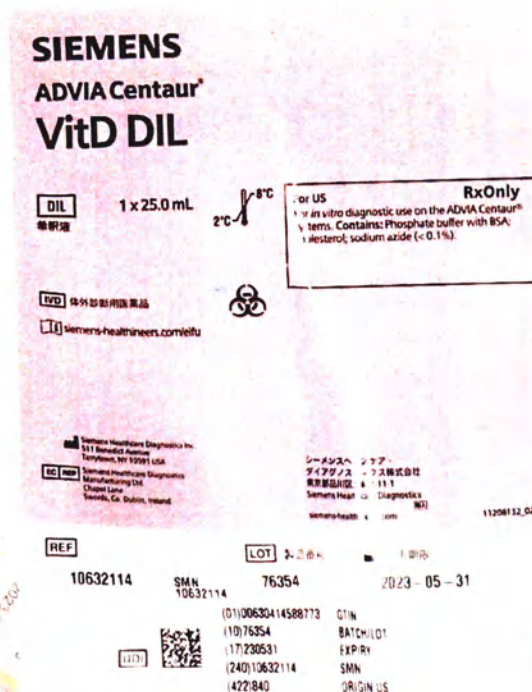


Рисунок 28 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон) (общий вид)



Рисунок 29 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон) (флакон)

10632114

Набор реагентов для определения общего витамина Д (ADVIA Centaur Vit D), для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии «ADVIA Centaur» («АДВИЯ Кентавр»): дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон)

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/6107 от 15.11.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 30 Дилуент для общего витамина D, ADVIA Centaur Vitamin D Diluent (Vit D DIL) (25мл/флакон): макет русскоязычной маркировки

Всего прошито и пронумеровано
31 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

