


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДЖЕНОМИКО»
Л.Д.Оловянников




Фотографические изображения медицинского изделия :


Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A производства Bioneer Corporation 8-11, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302, Republic of Korea

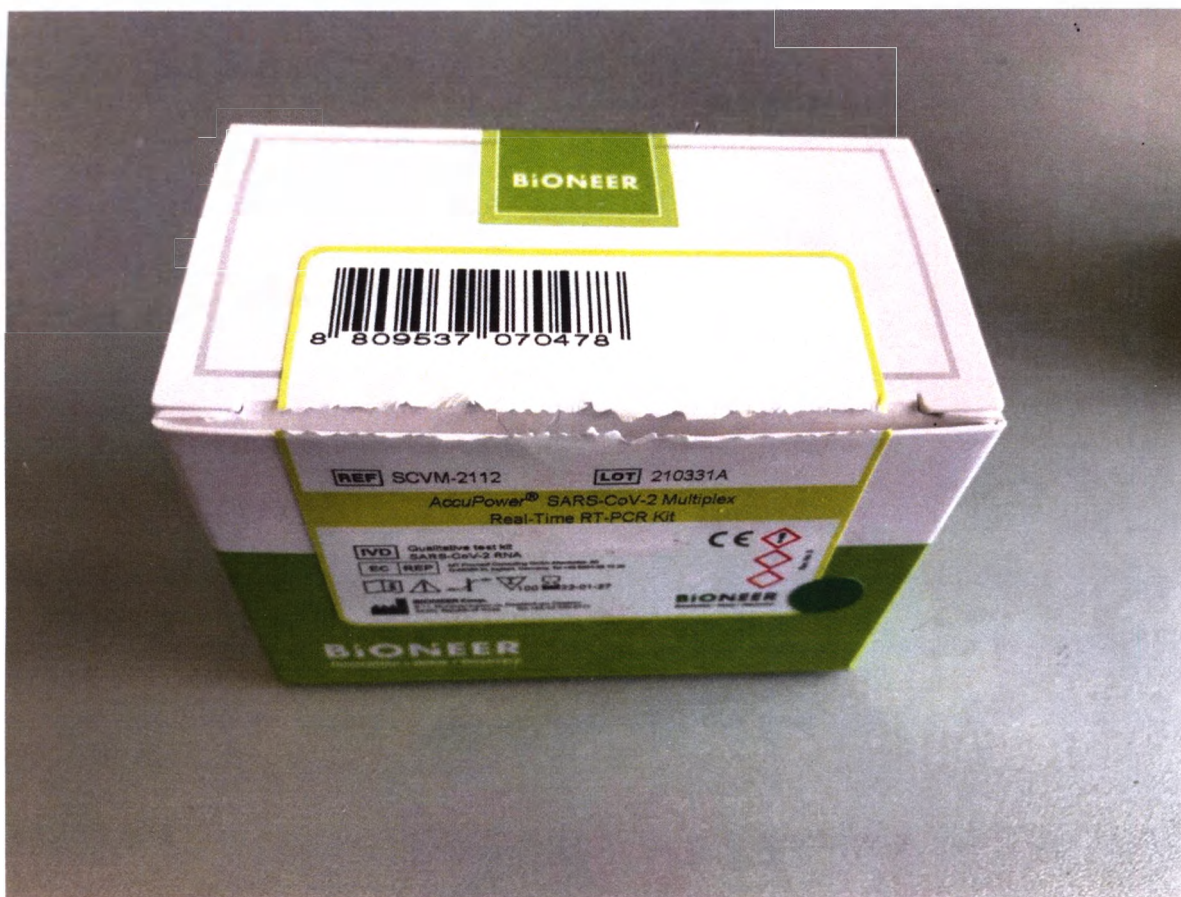

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A)

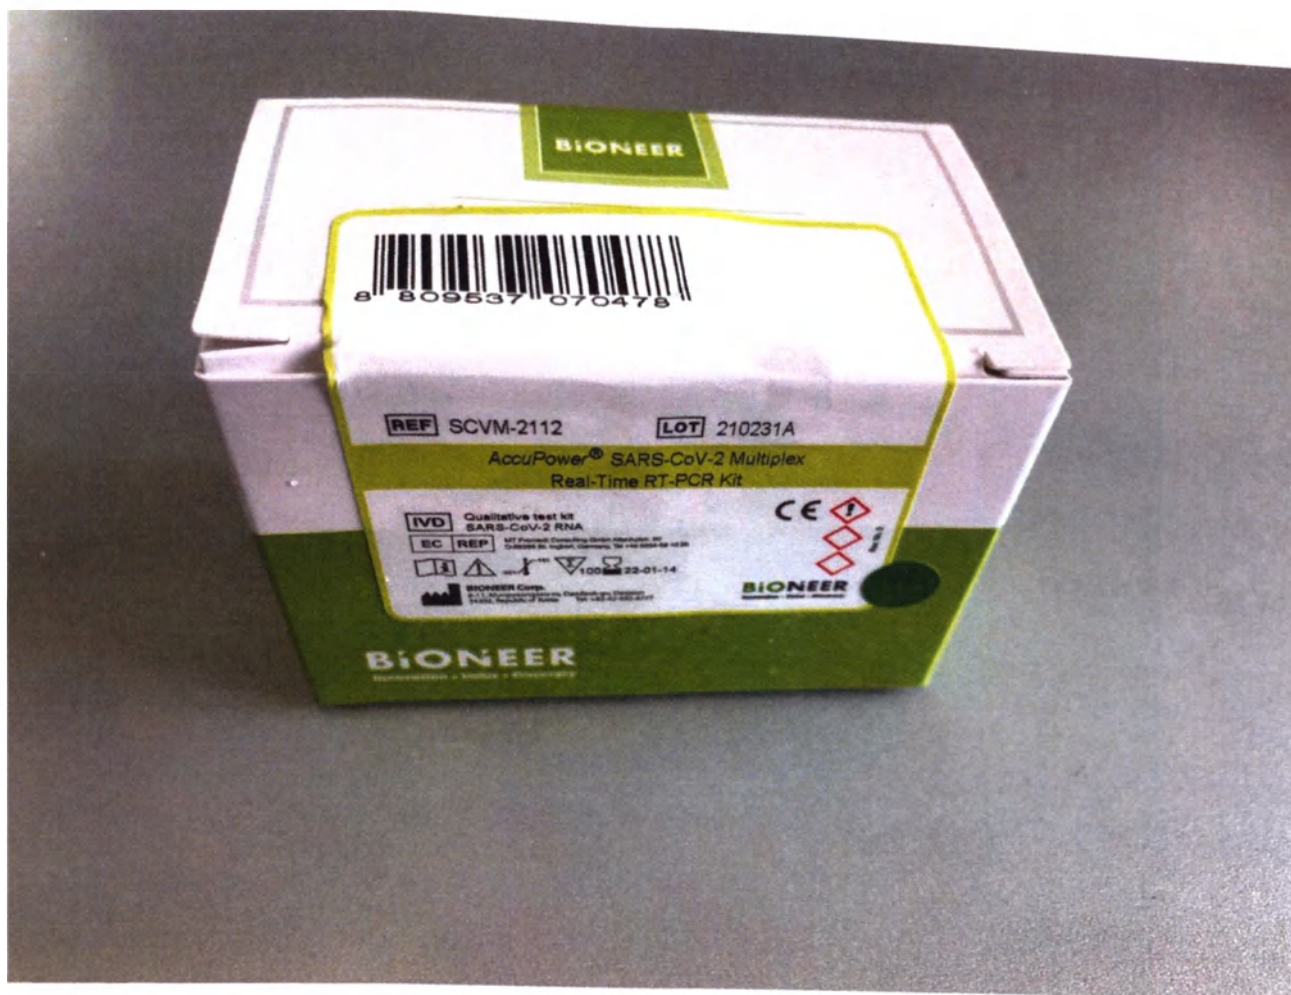


Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210231A)

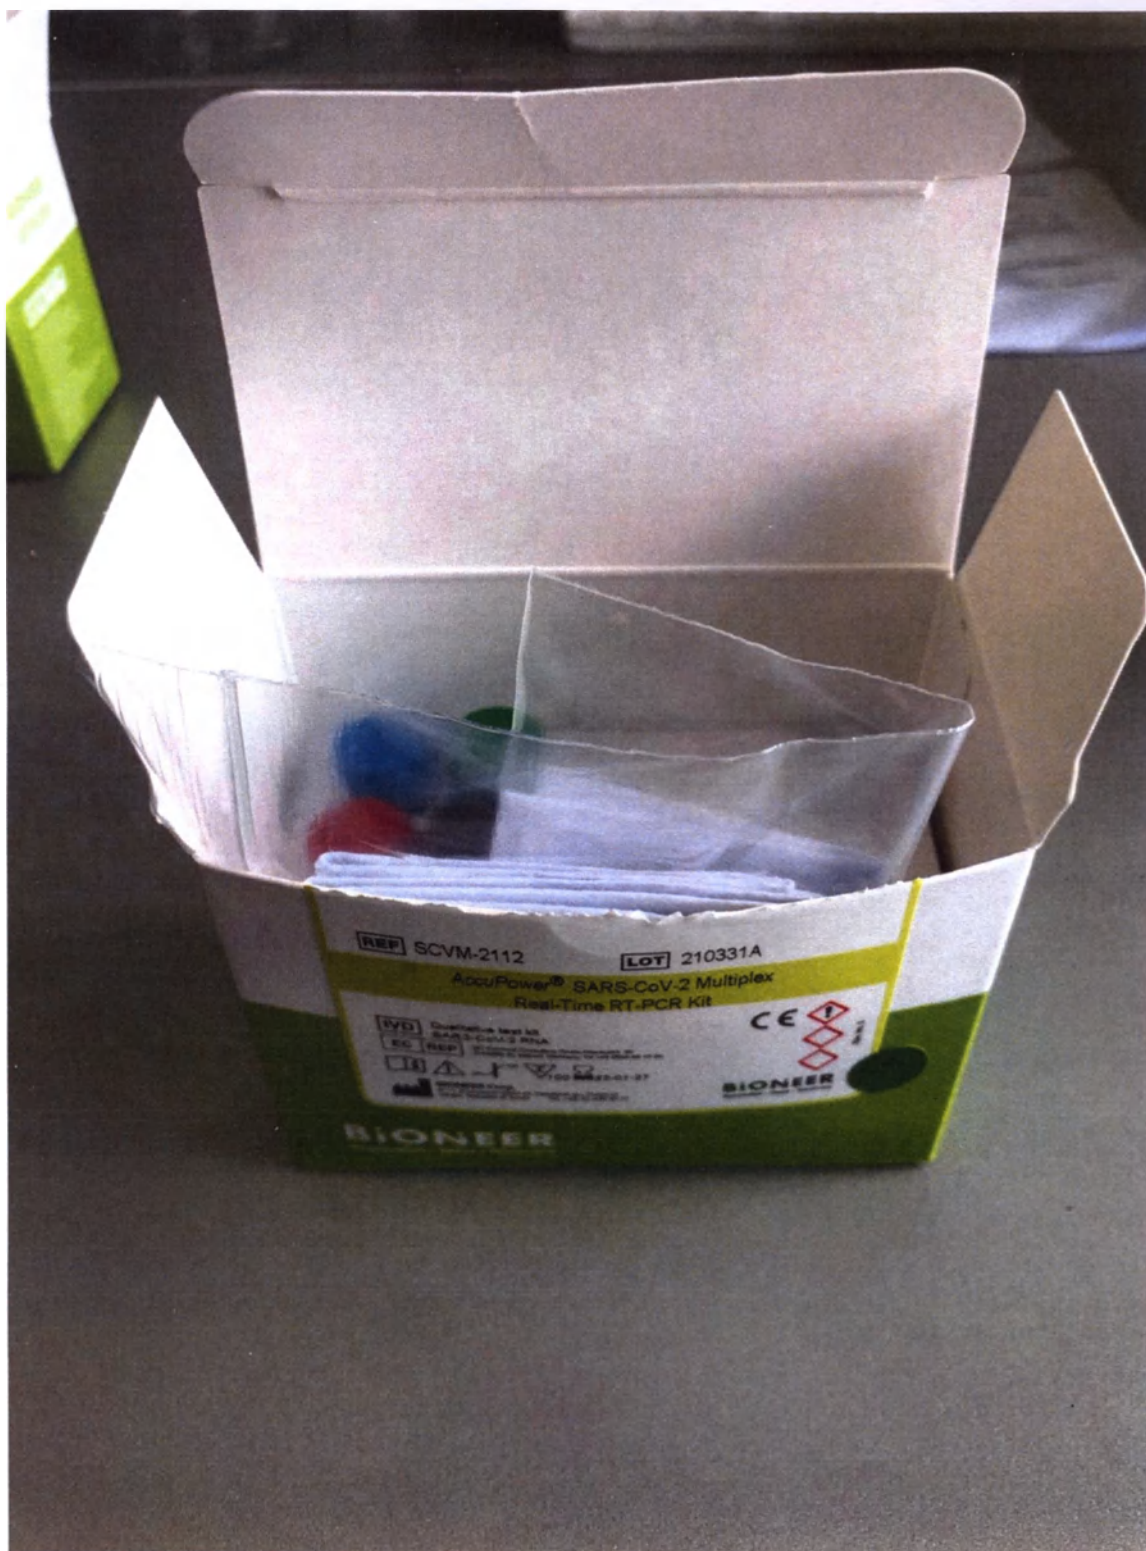


Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A, открытая упаковка вид сверху)



Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A, открытая упаковка вид сверху)

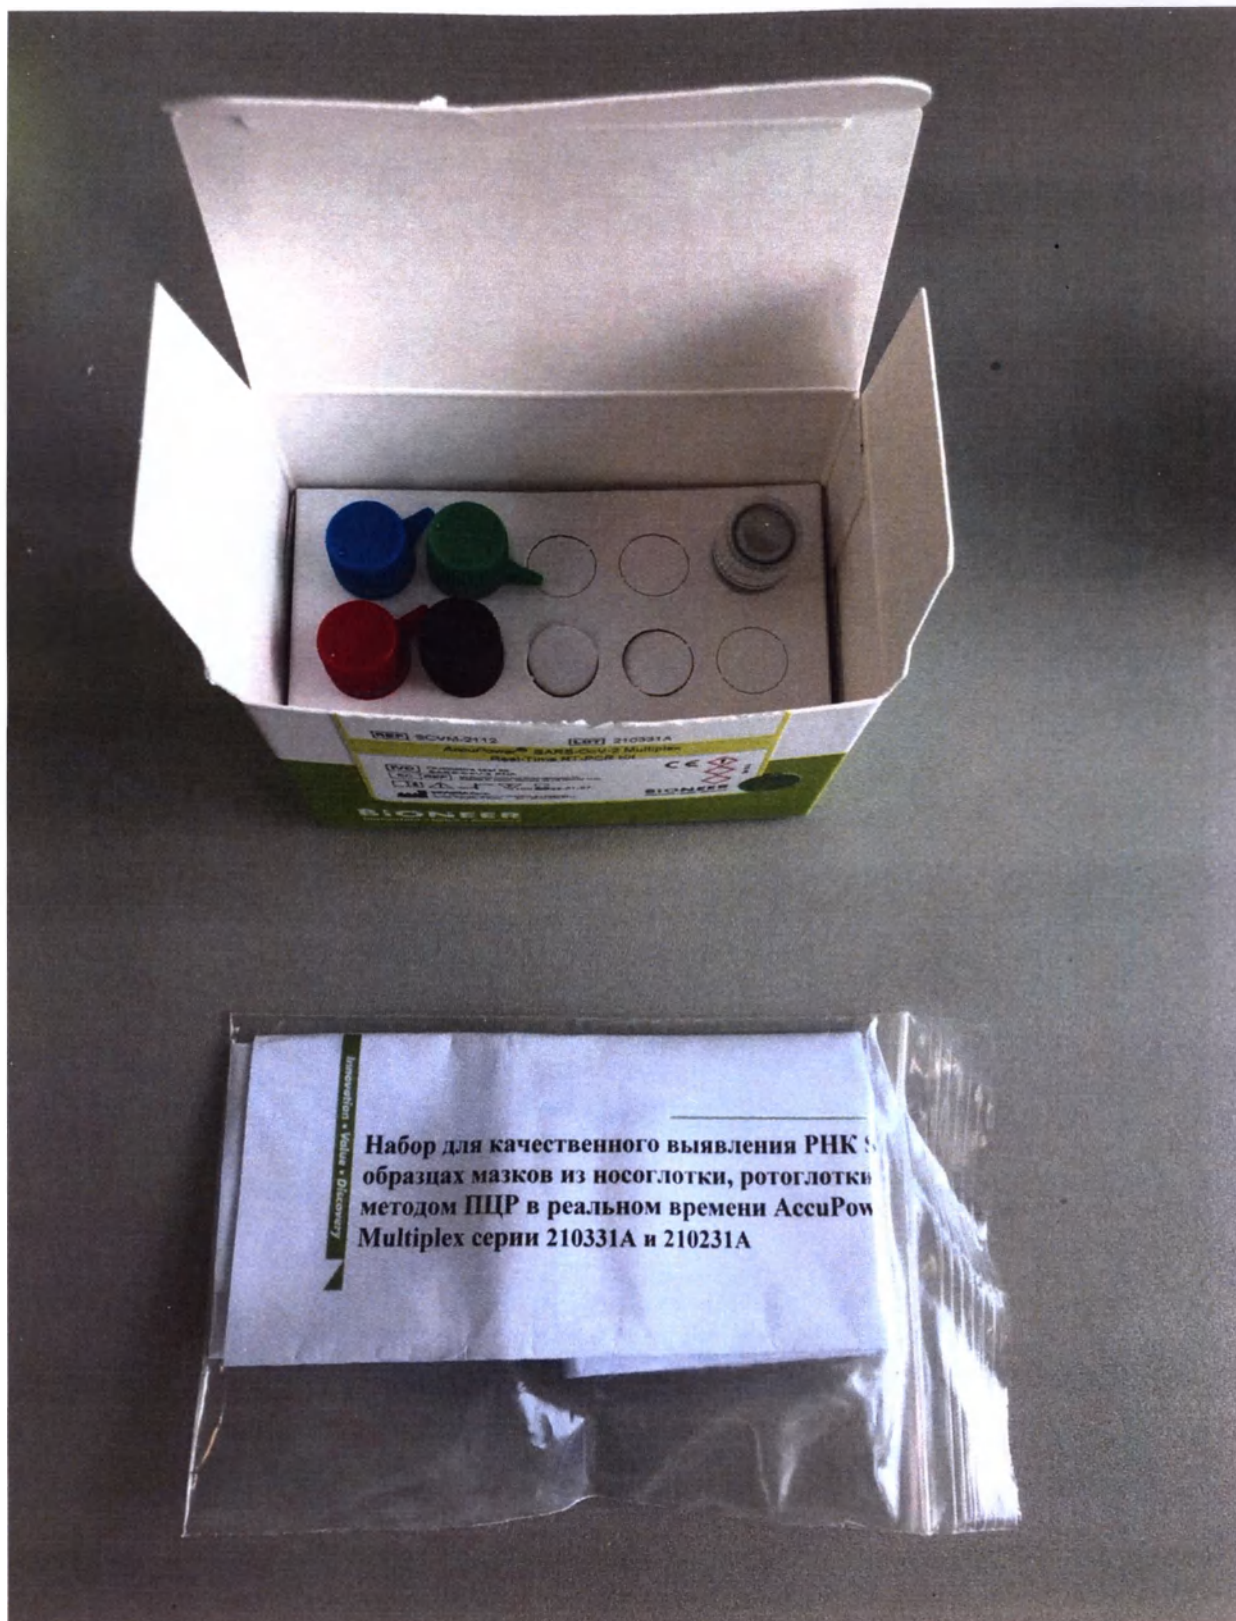

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A, открытая упаковка вид сверху)

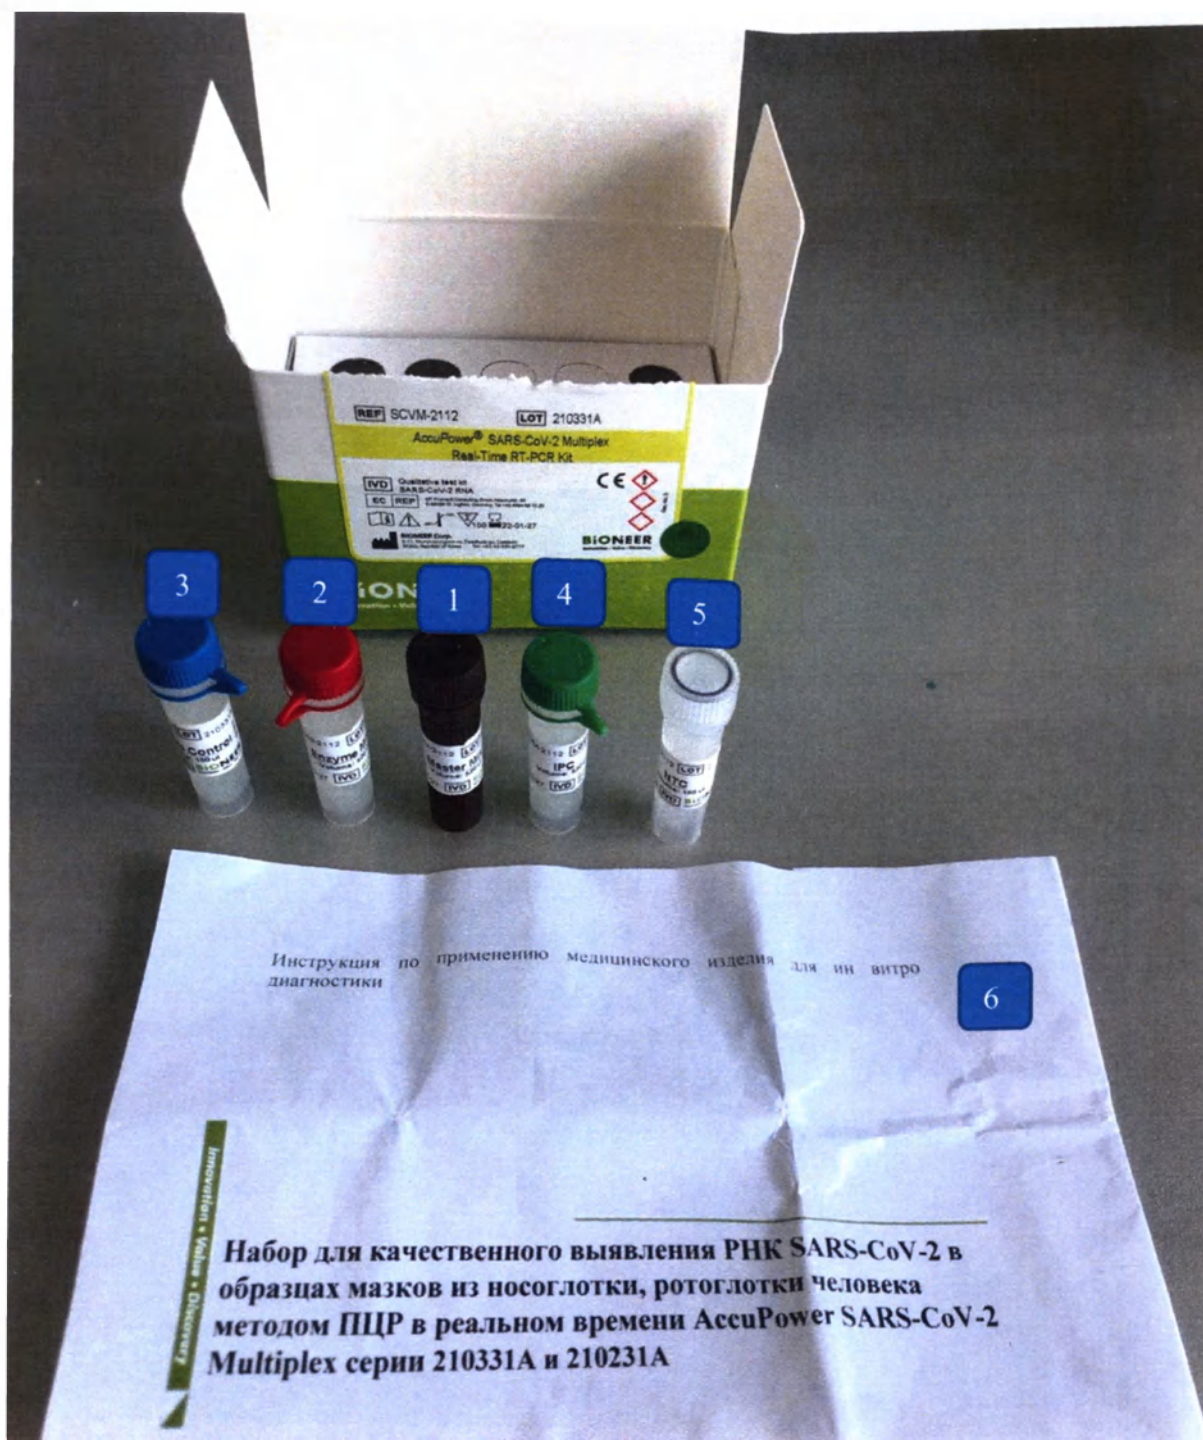


Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A):


1. Мастермикс – 1 пробирка 520 мкл;
2. Ферментная смесь – 1 пробирка 520 мкл;
3. Положительный контроль – 1 пробирка 150 мкл;
4. Внутренний контроль – 1 пробирка 520 мкл;
5. Отрицательный контроль – 1 пробирка 150 мкл;
6. Инструкция по применению – 1 шт.




Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A): Мастермикс - пробирка 520 мкл;

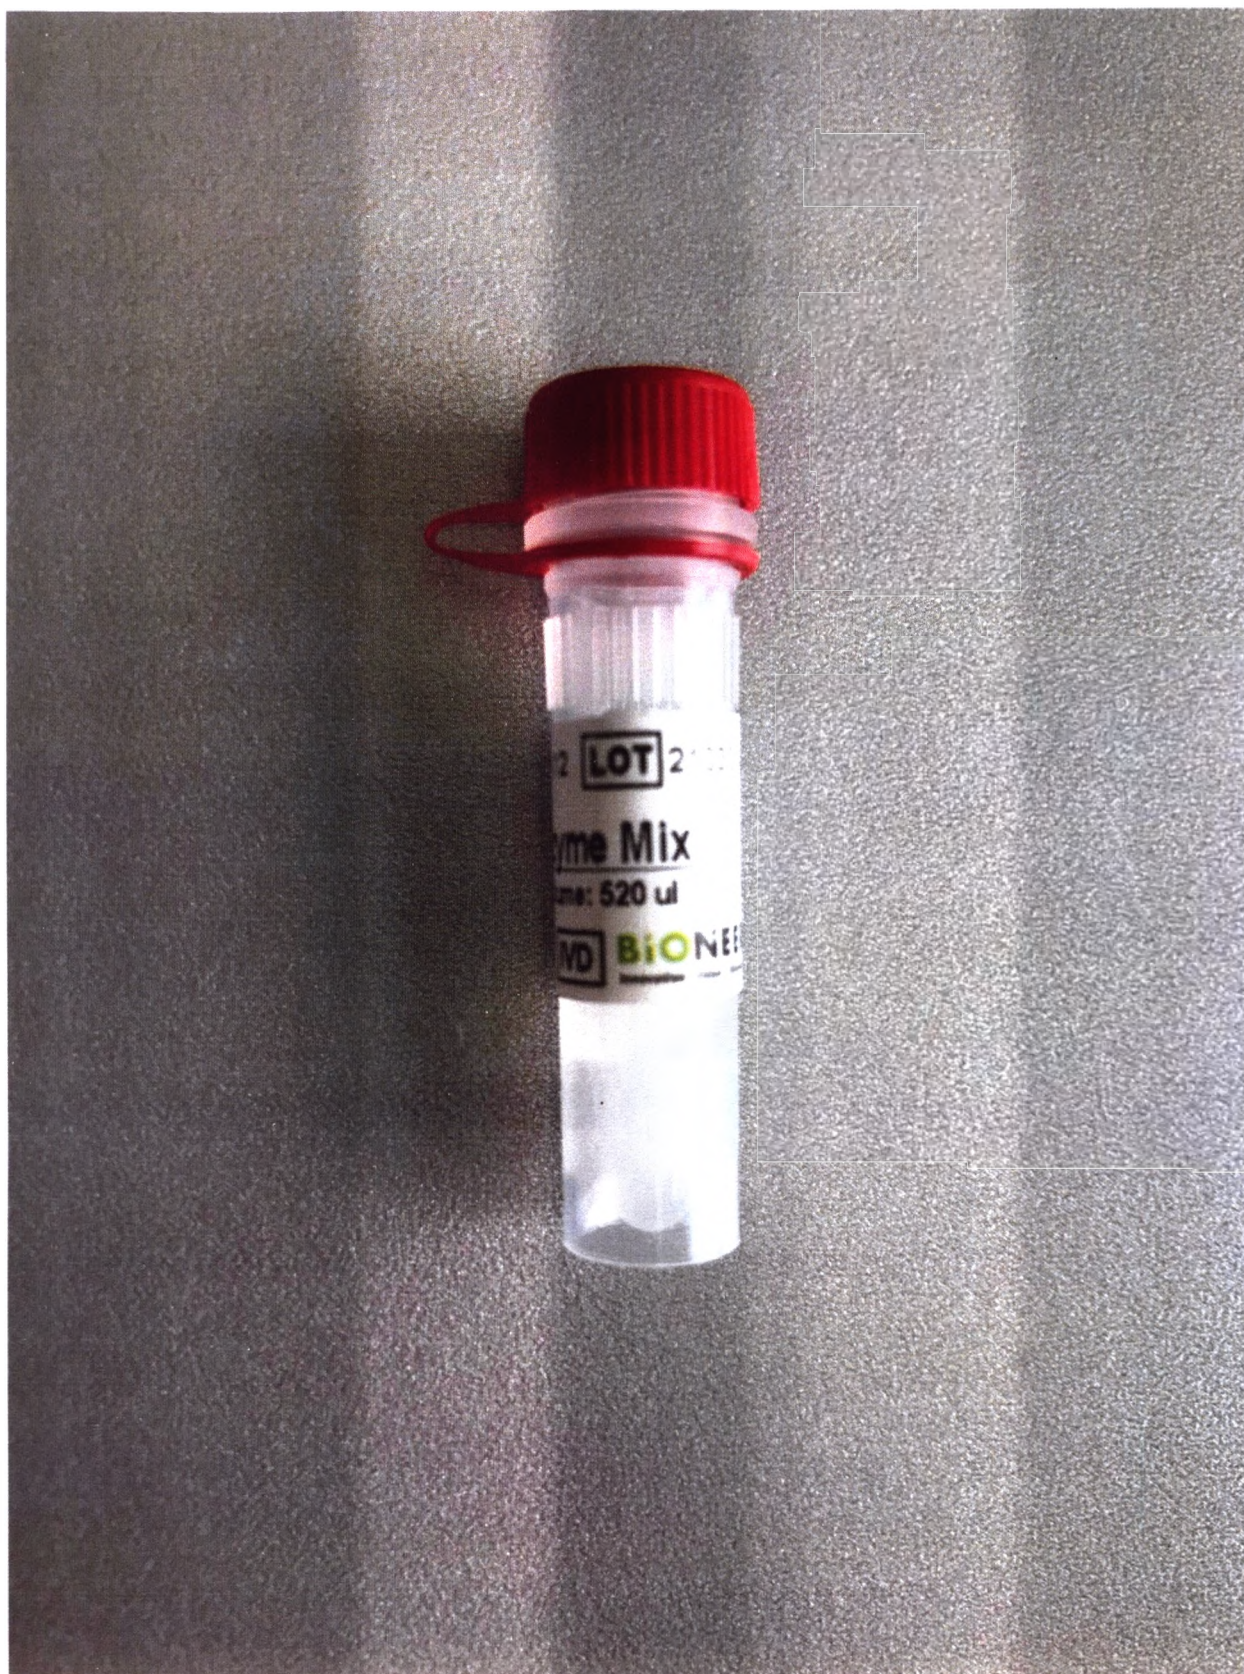


Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A): Ферментная смесь - пробирка 520 мкл;

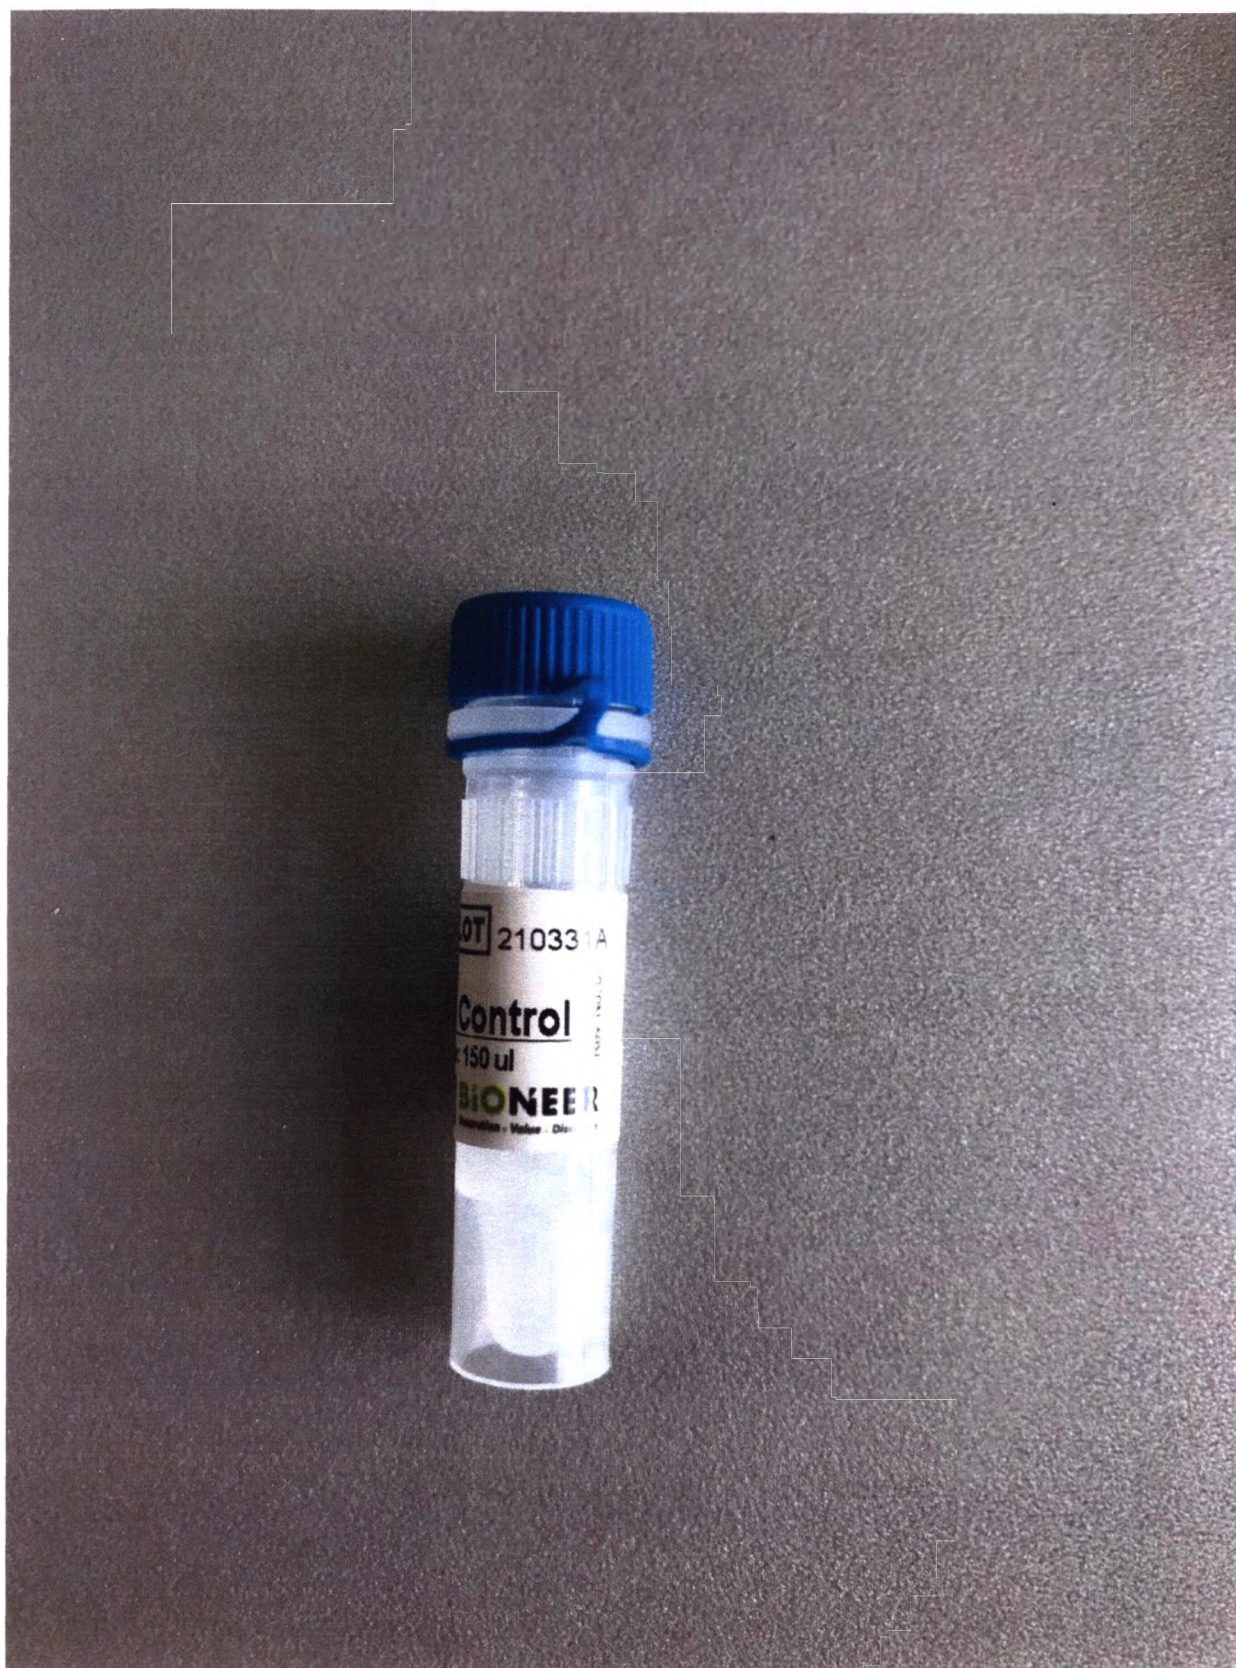

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A): Положительный контроль - пробирка 150 мкл;

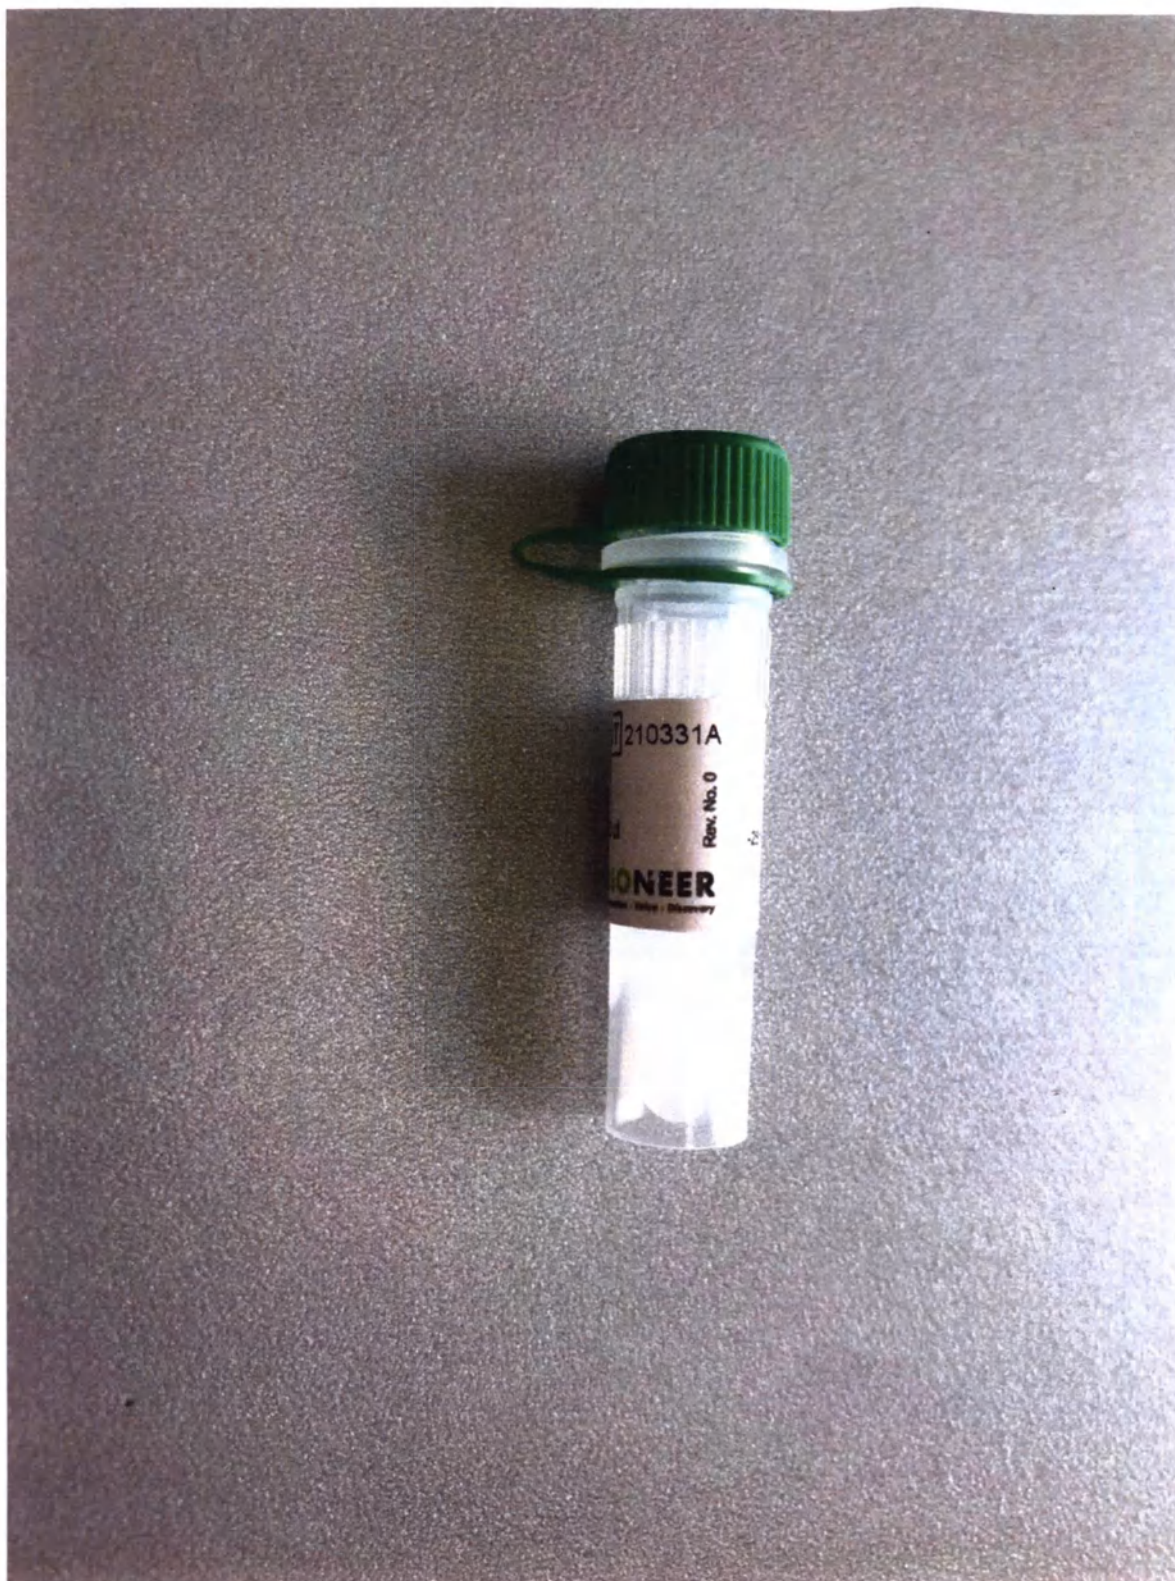

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A): Внутренний контроль -пробирка 520 мкл;

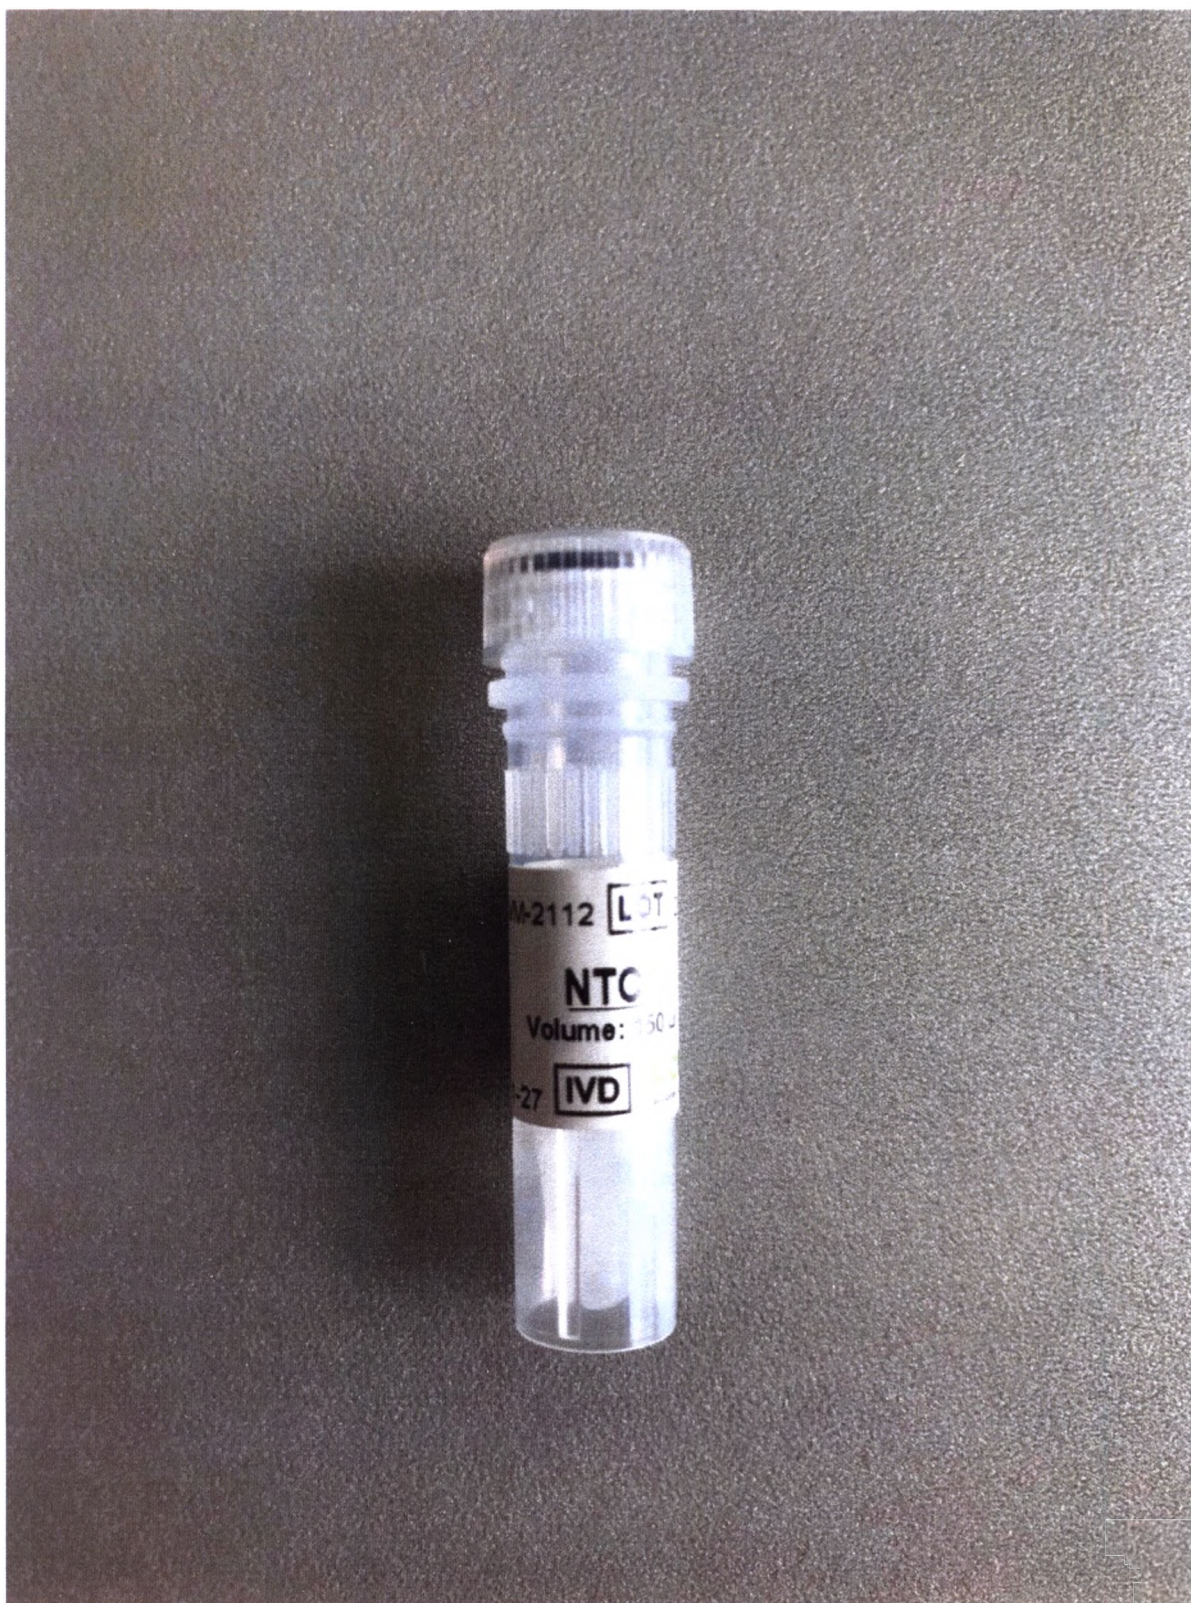

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A (серия 210331A): Отрицательный контроль пробирка 150 мкл

Генеральный директор
ООО «ДЖЕНОМИКО»
Л.Д. Оловянников



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО
«ДЖЕНОМИКО»
Л.Д.Оловянников



Макет маркировки для медицинского изделия :

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A

Производства Bioneer Corporation 8-11, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302, Republic of Korea

Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, ротоглотки человека методом ПЦР в реальном времени AccuPower SARS-CoV-2 Multiplex серии 210331A и 210231A

Номер серии: см оригинальную упаковку

Состав набора:

1. Мастермикс - 1 пробирка 520 мкл;
2. Ферментная смесь – 1 пробирка 520 мкл;
3. Положительный контроль – 1 пробирка 150 мкл;
4. Внутренний контроль -1 пробирка 520 мкл;
5. Отрицательный контроль 1 пробирка 150 мкл;
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Изготовитель: Bioneer Corporation (Бионир Корпорейшн) 8-11, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302, Корея;

Содержимое набора предназначено на 100 тестов.

Хранить при температуре от -25 до -15 °C

Срок годности 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на оригинальной упаковке изготовителя);

Регистрационное удостоверение: XXXXX от DD.MM.YYYY

Для диагностики ин-витро.

Прошито и пронумеровано

2 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «ДЖЕНОМИКО»

Л.Д. Оловянников

