

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор
ООО "Миндрей Медикал Рус"

(должность)

Сюн Вэй

(ФИО)



Сысов

(подпись)

М.П.


« 16 » июня 2021 г.


Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, варианты исполнения:
М6Т, М58, М6, М6 Exp, М6 Pro, М6s


2021г.

I. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М6Т
1. Основной блок М6Т

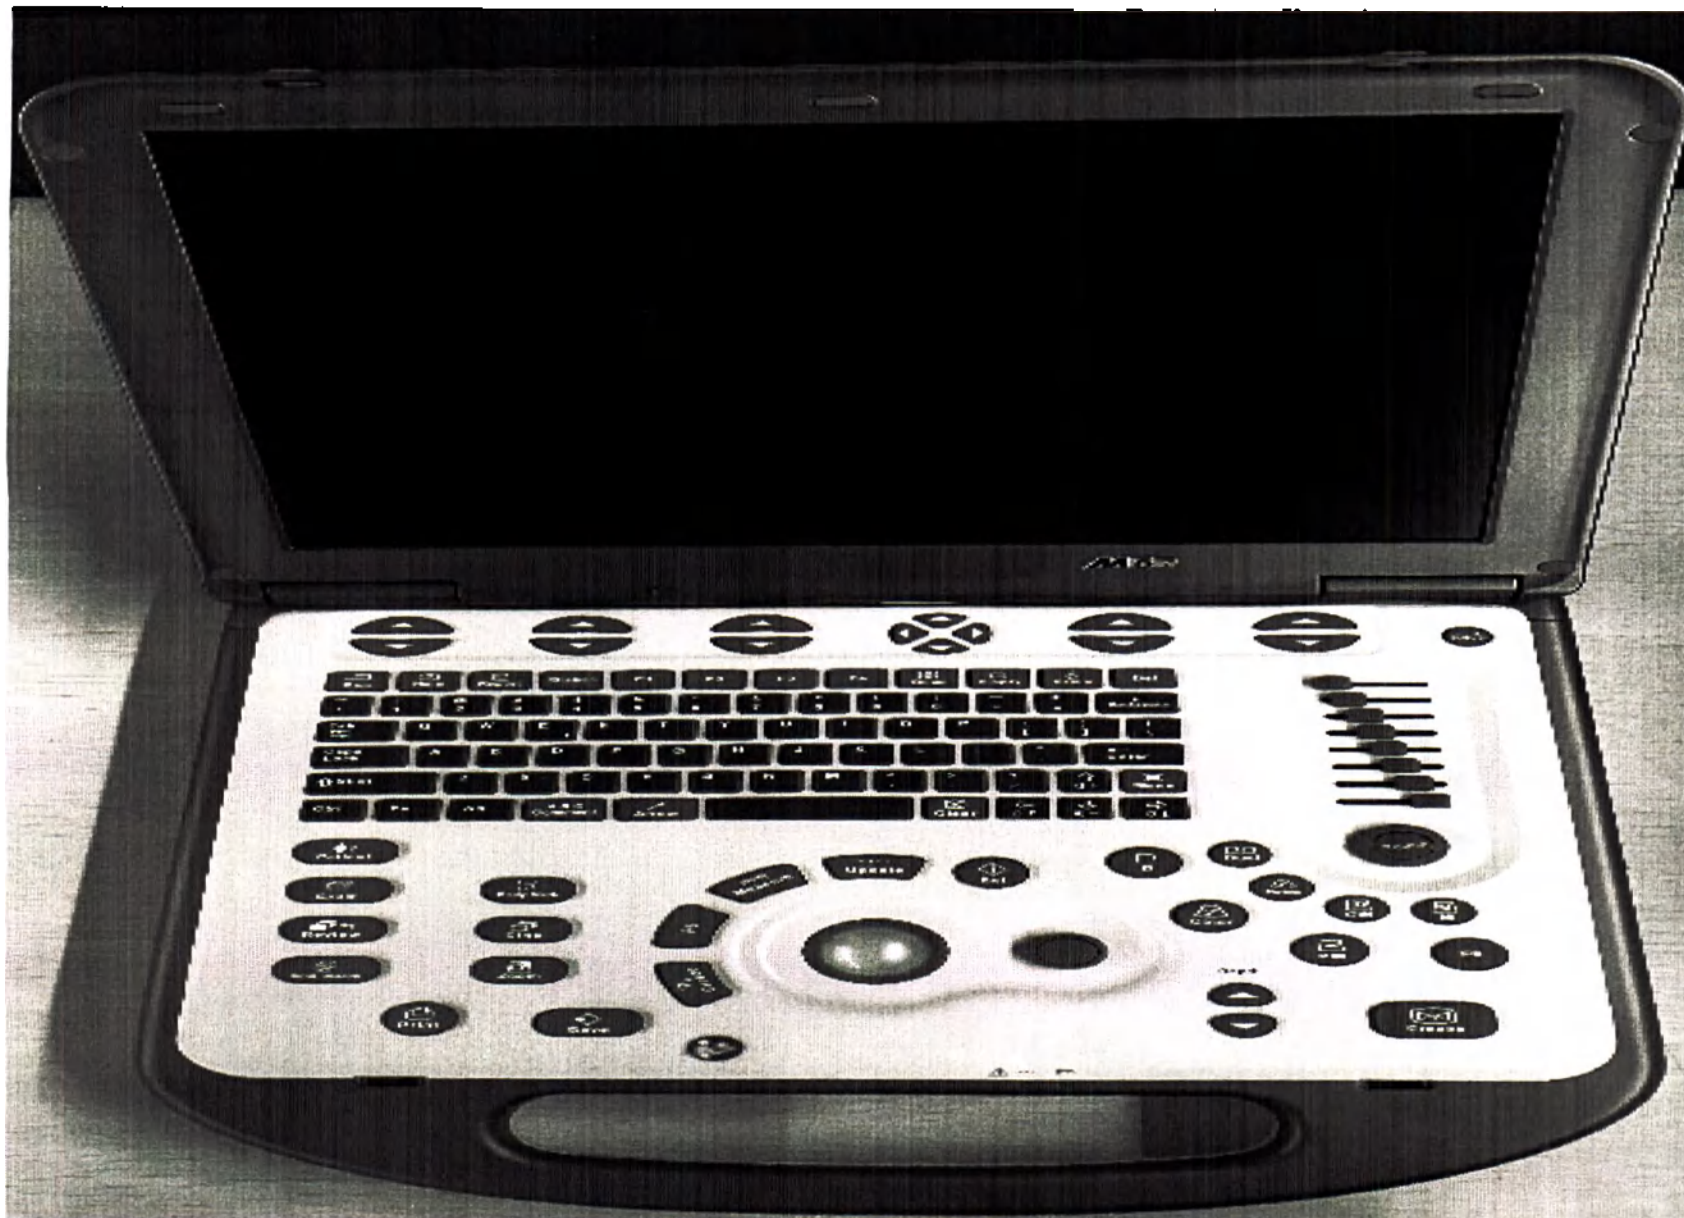


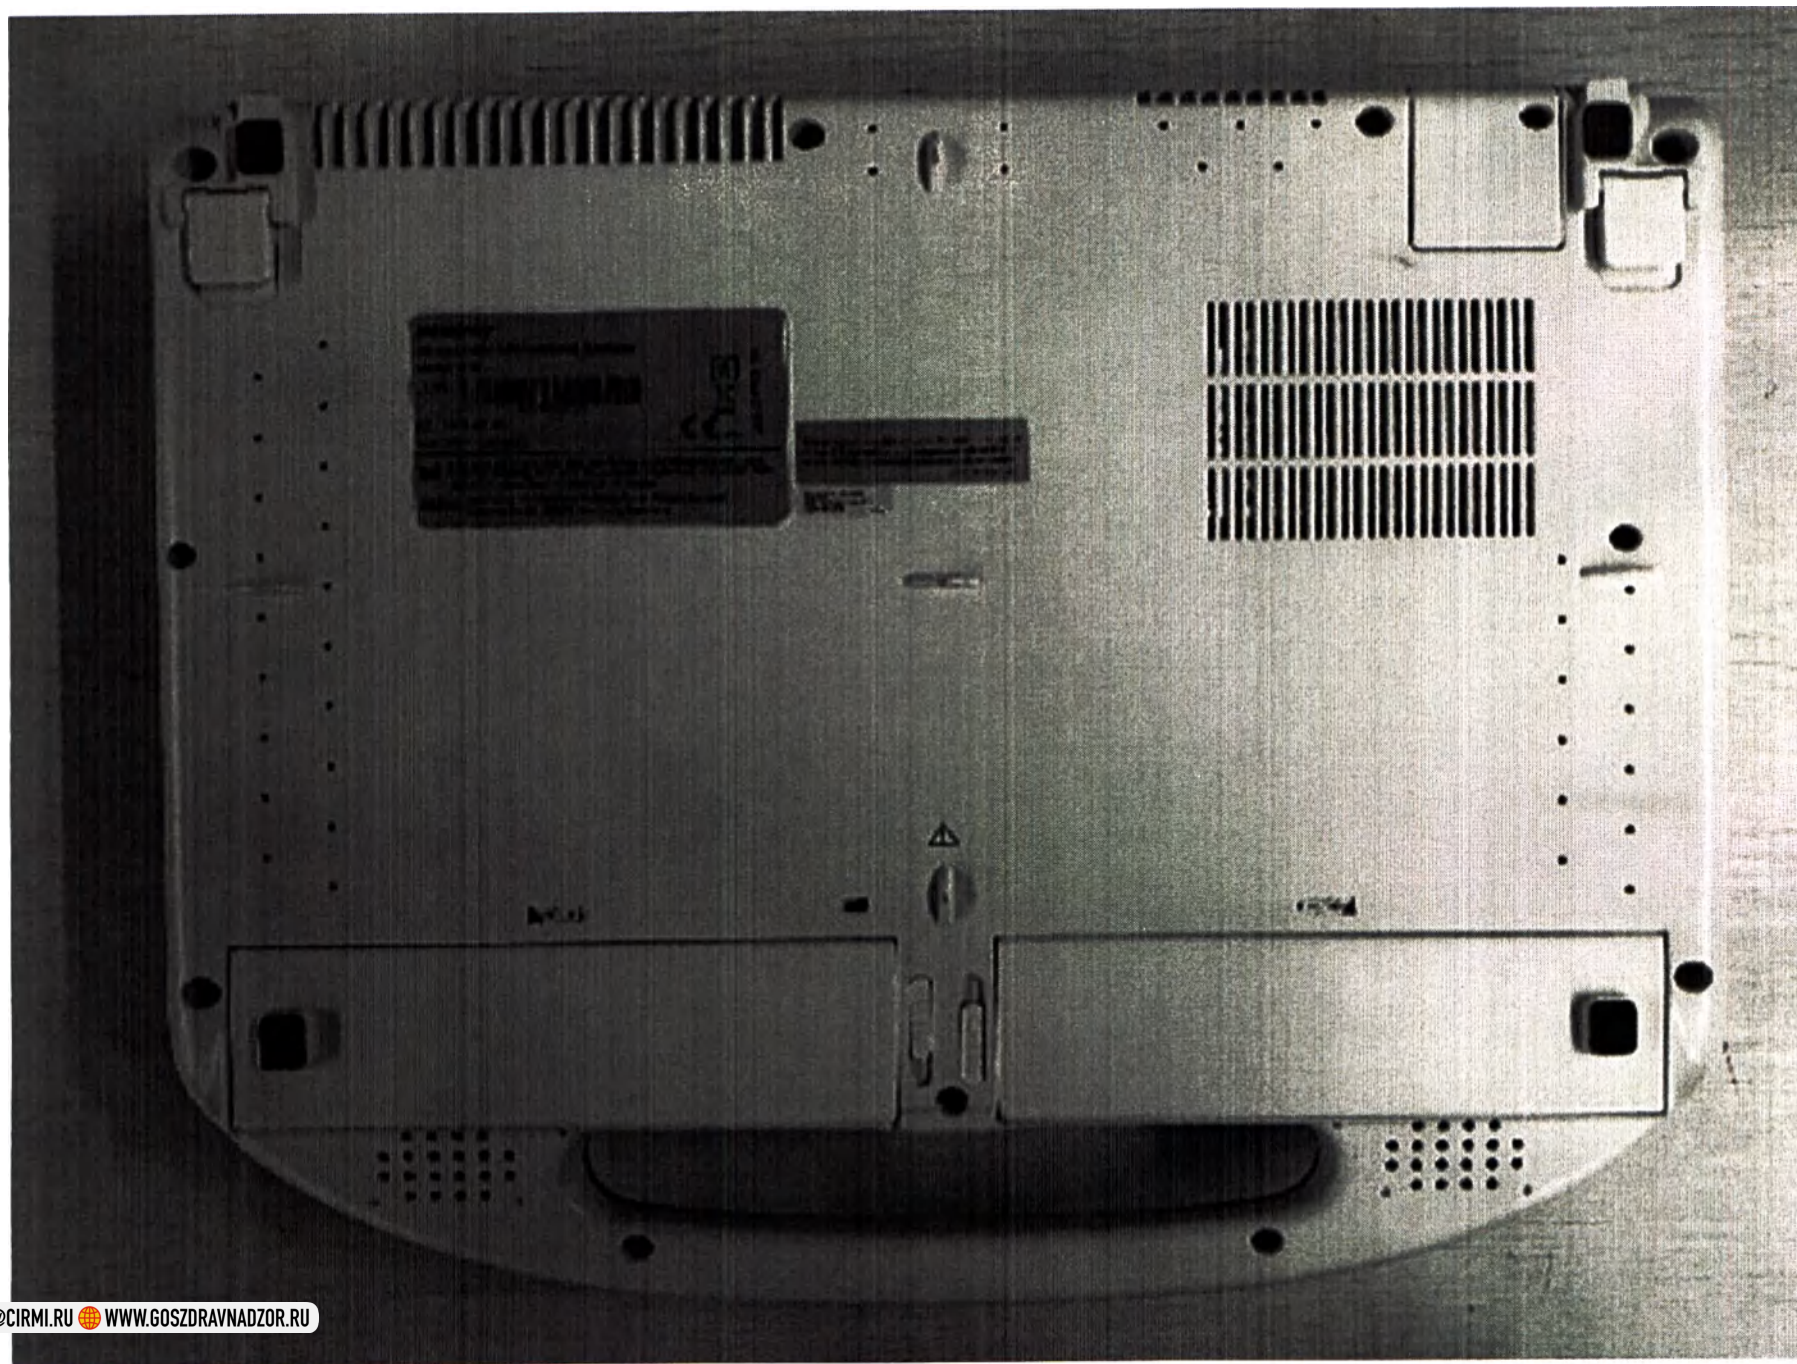

4. Кабель питания

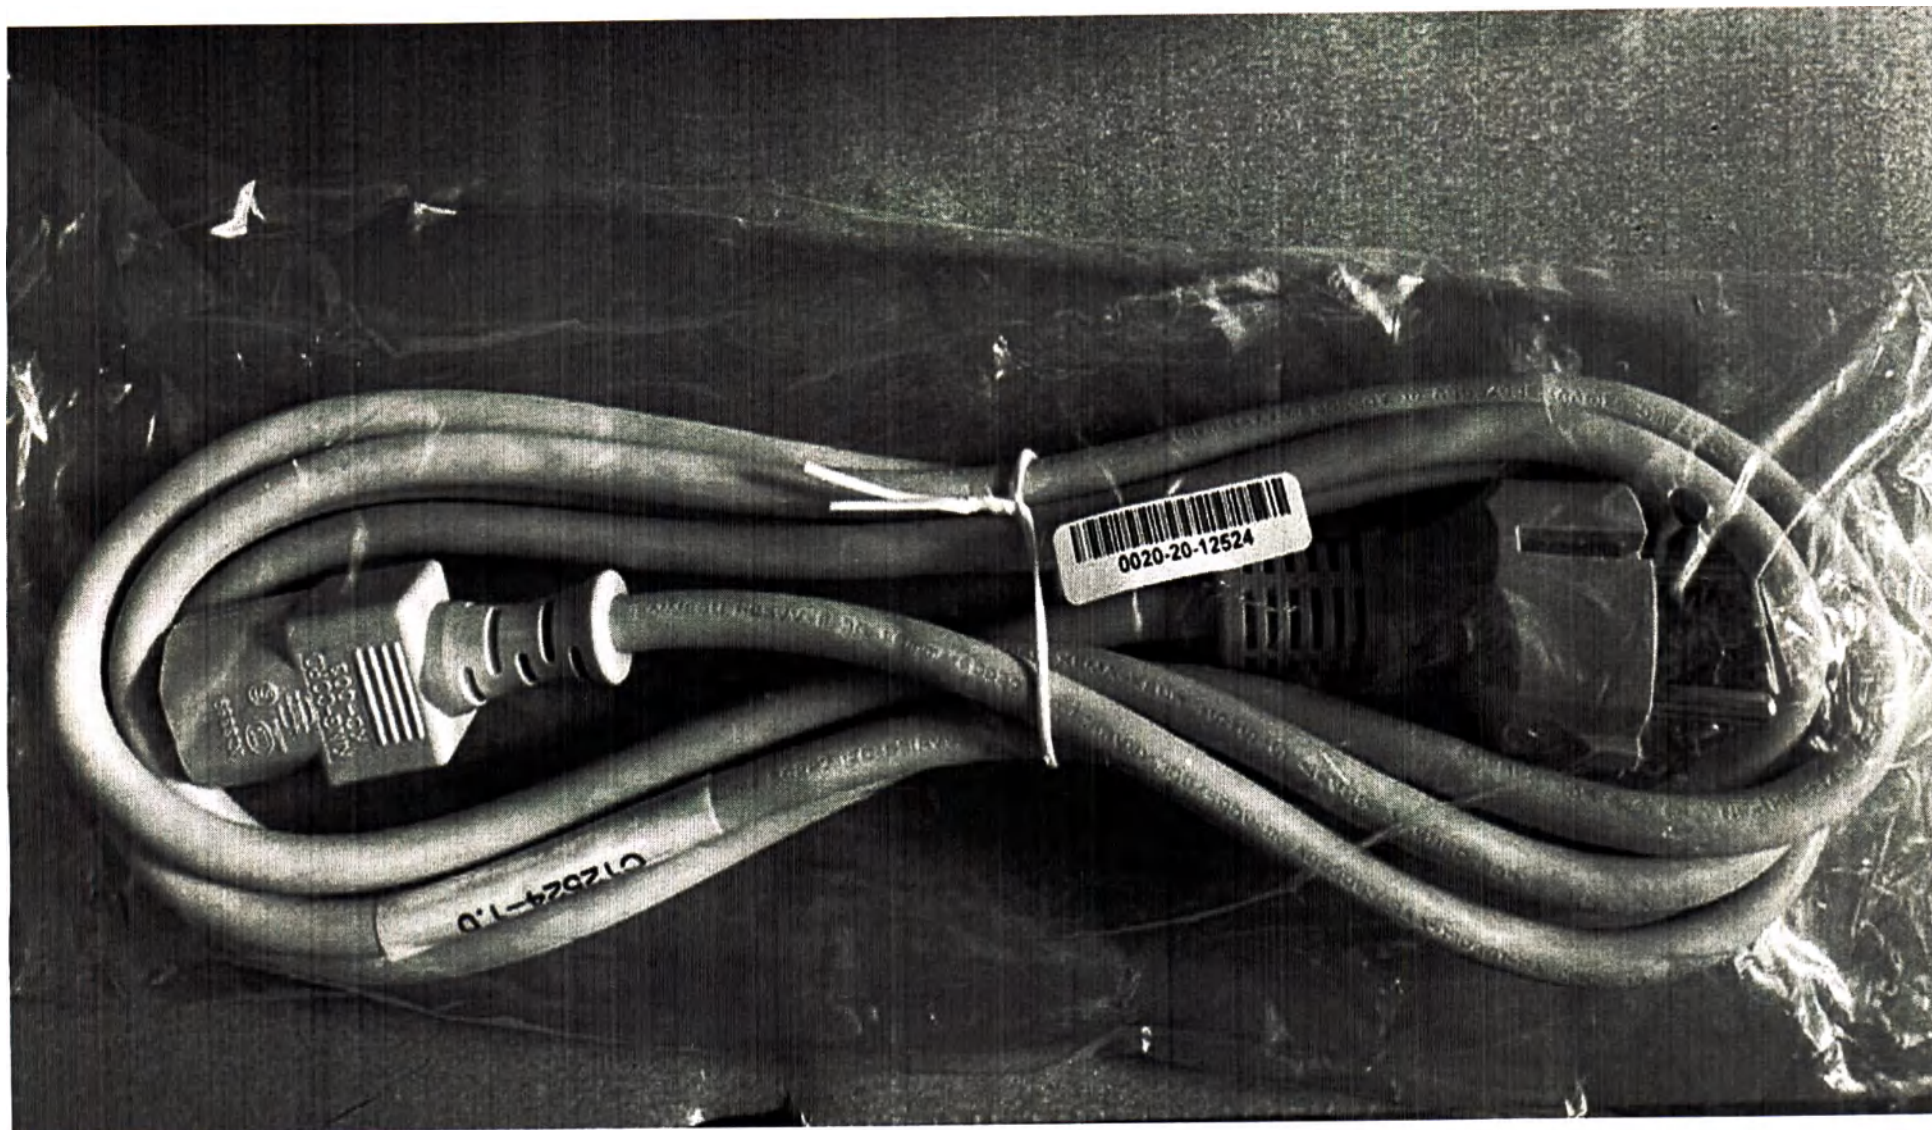

5. Накладка на панель управления(русифицированная)

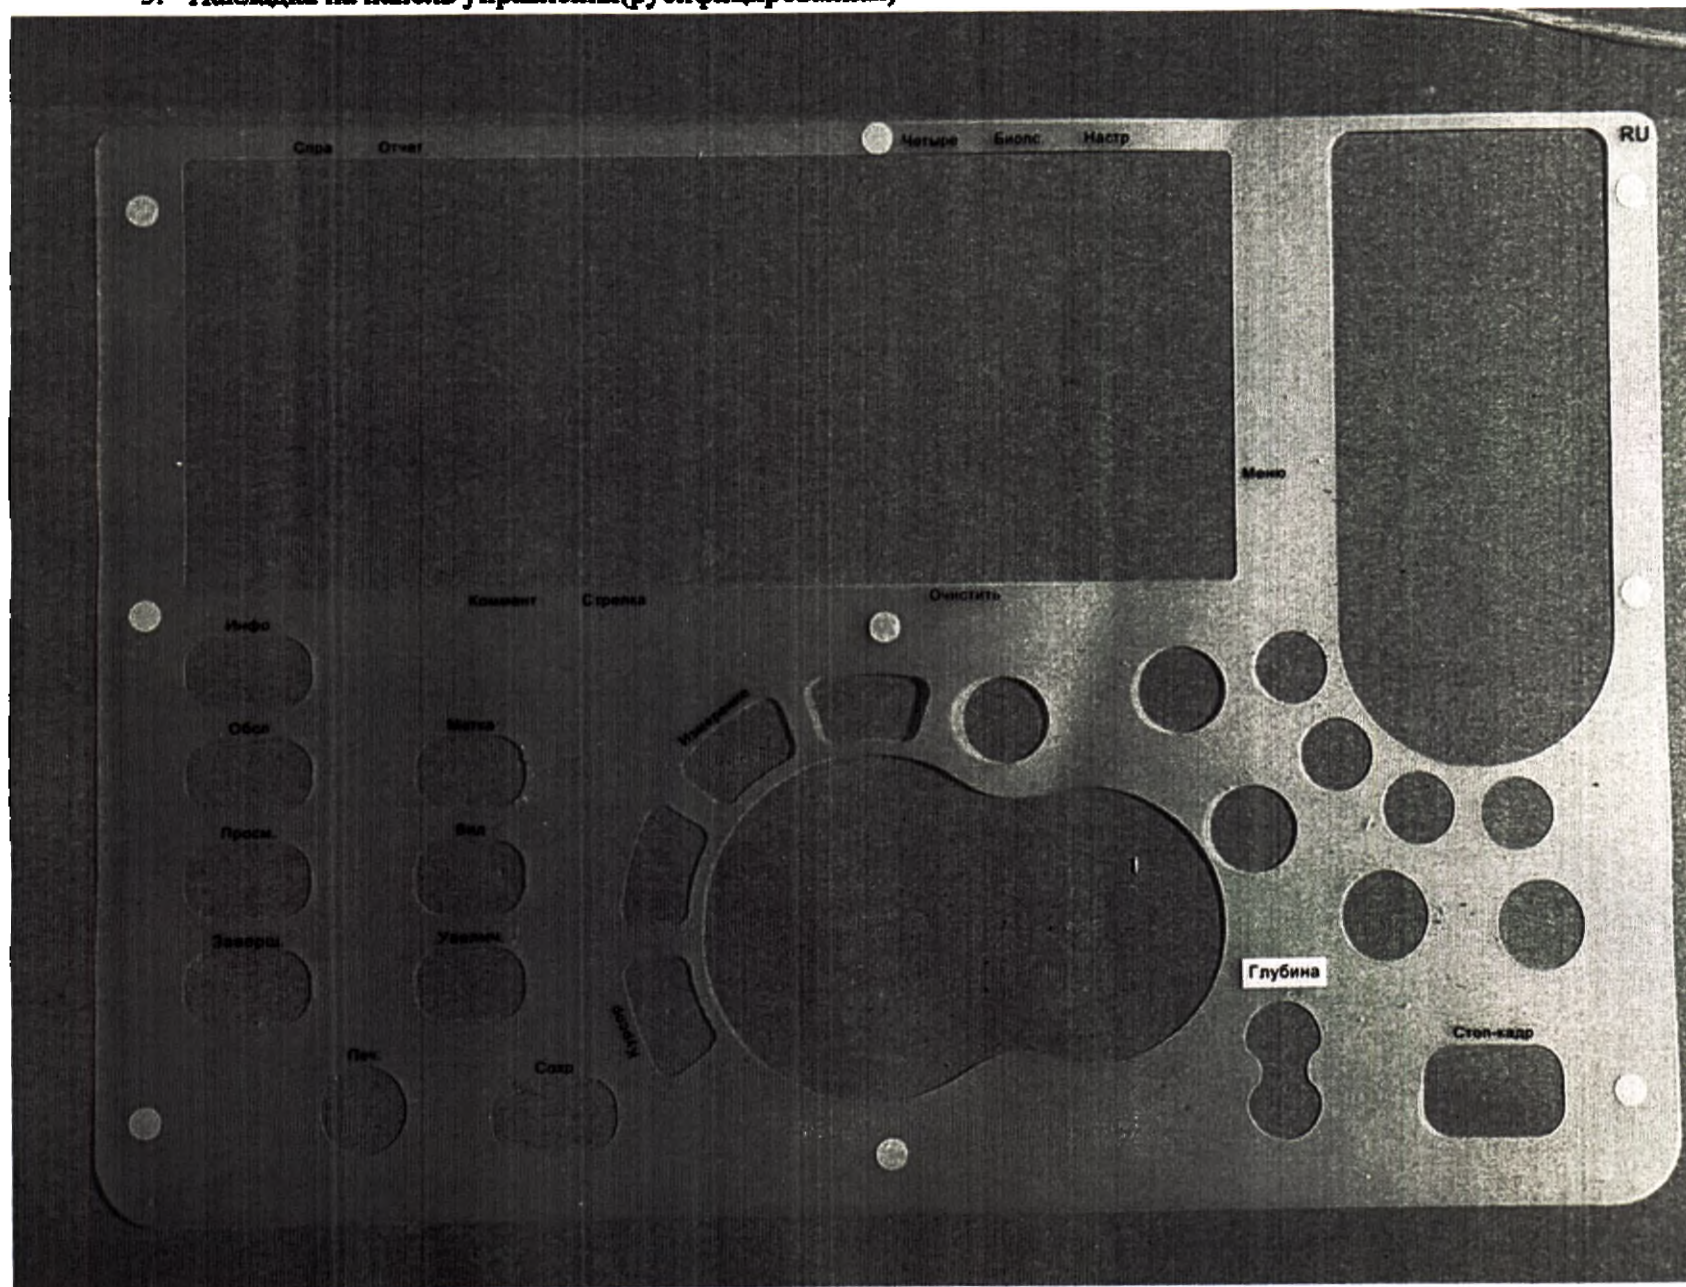


6. Адаптер питания




7. Аккумуляторная батарея




8. Разветвитель для датчиков

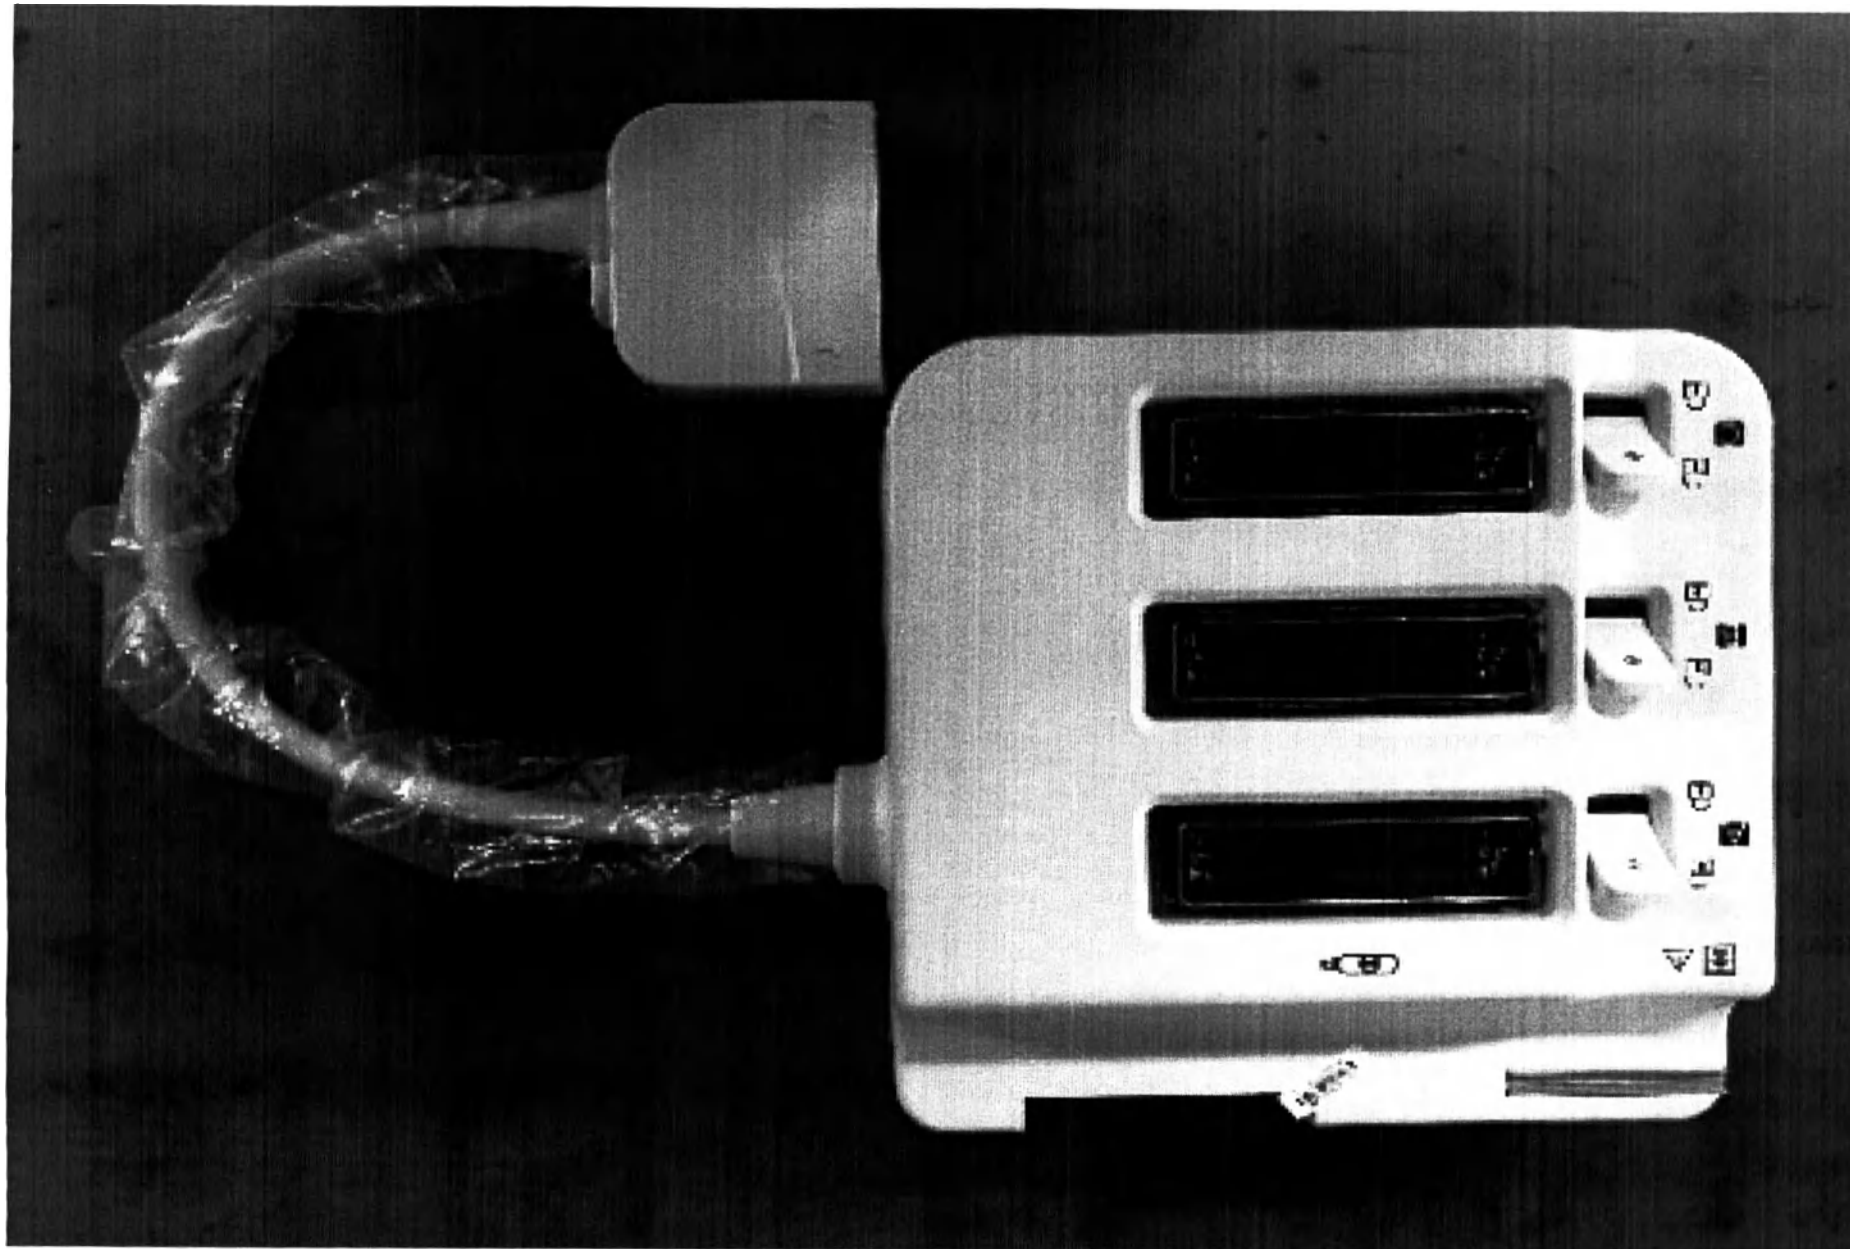


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

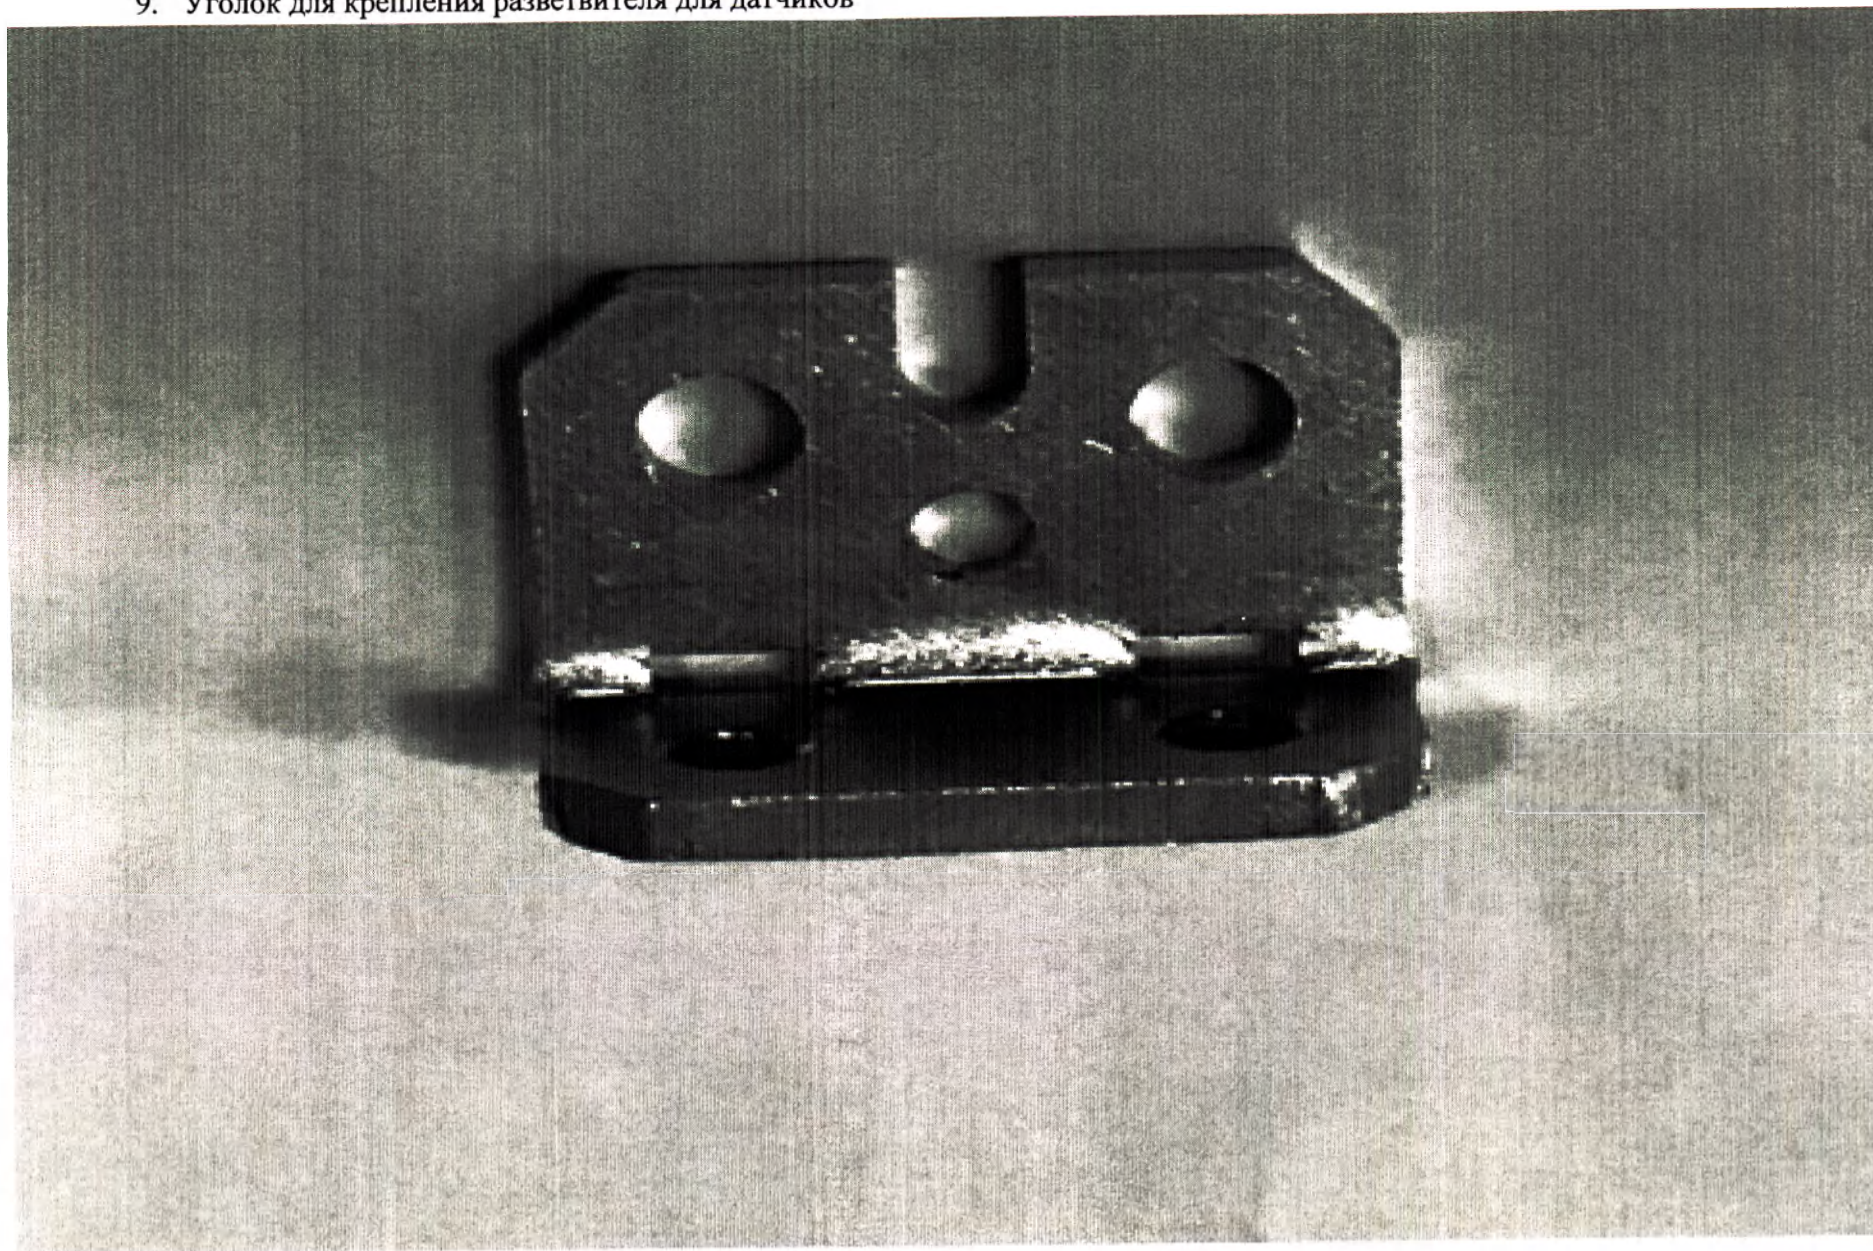


10. Заглушка порта датчика

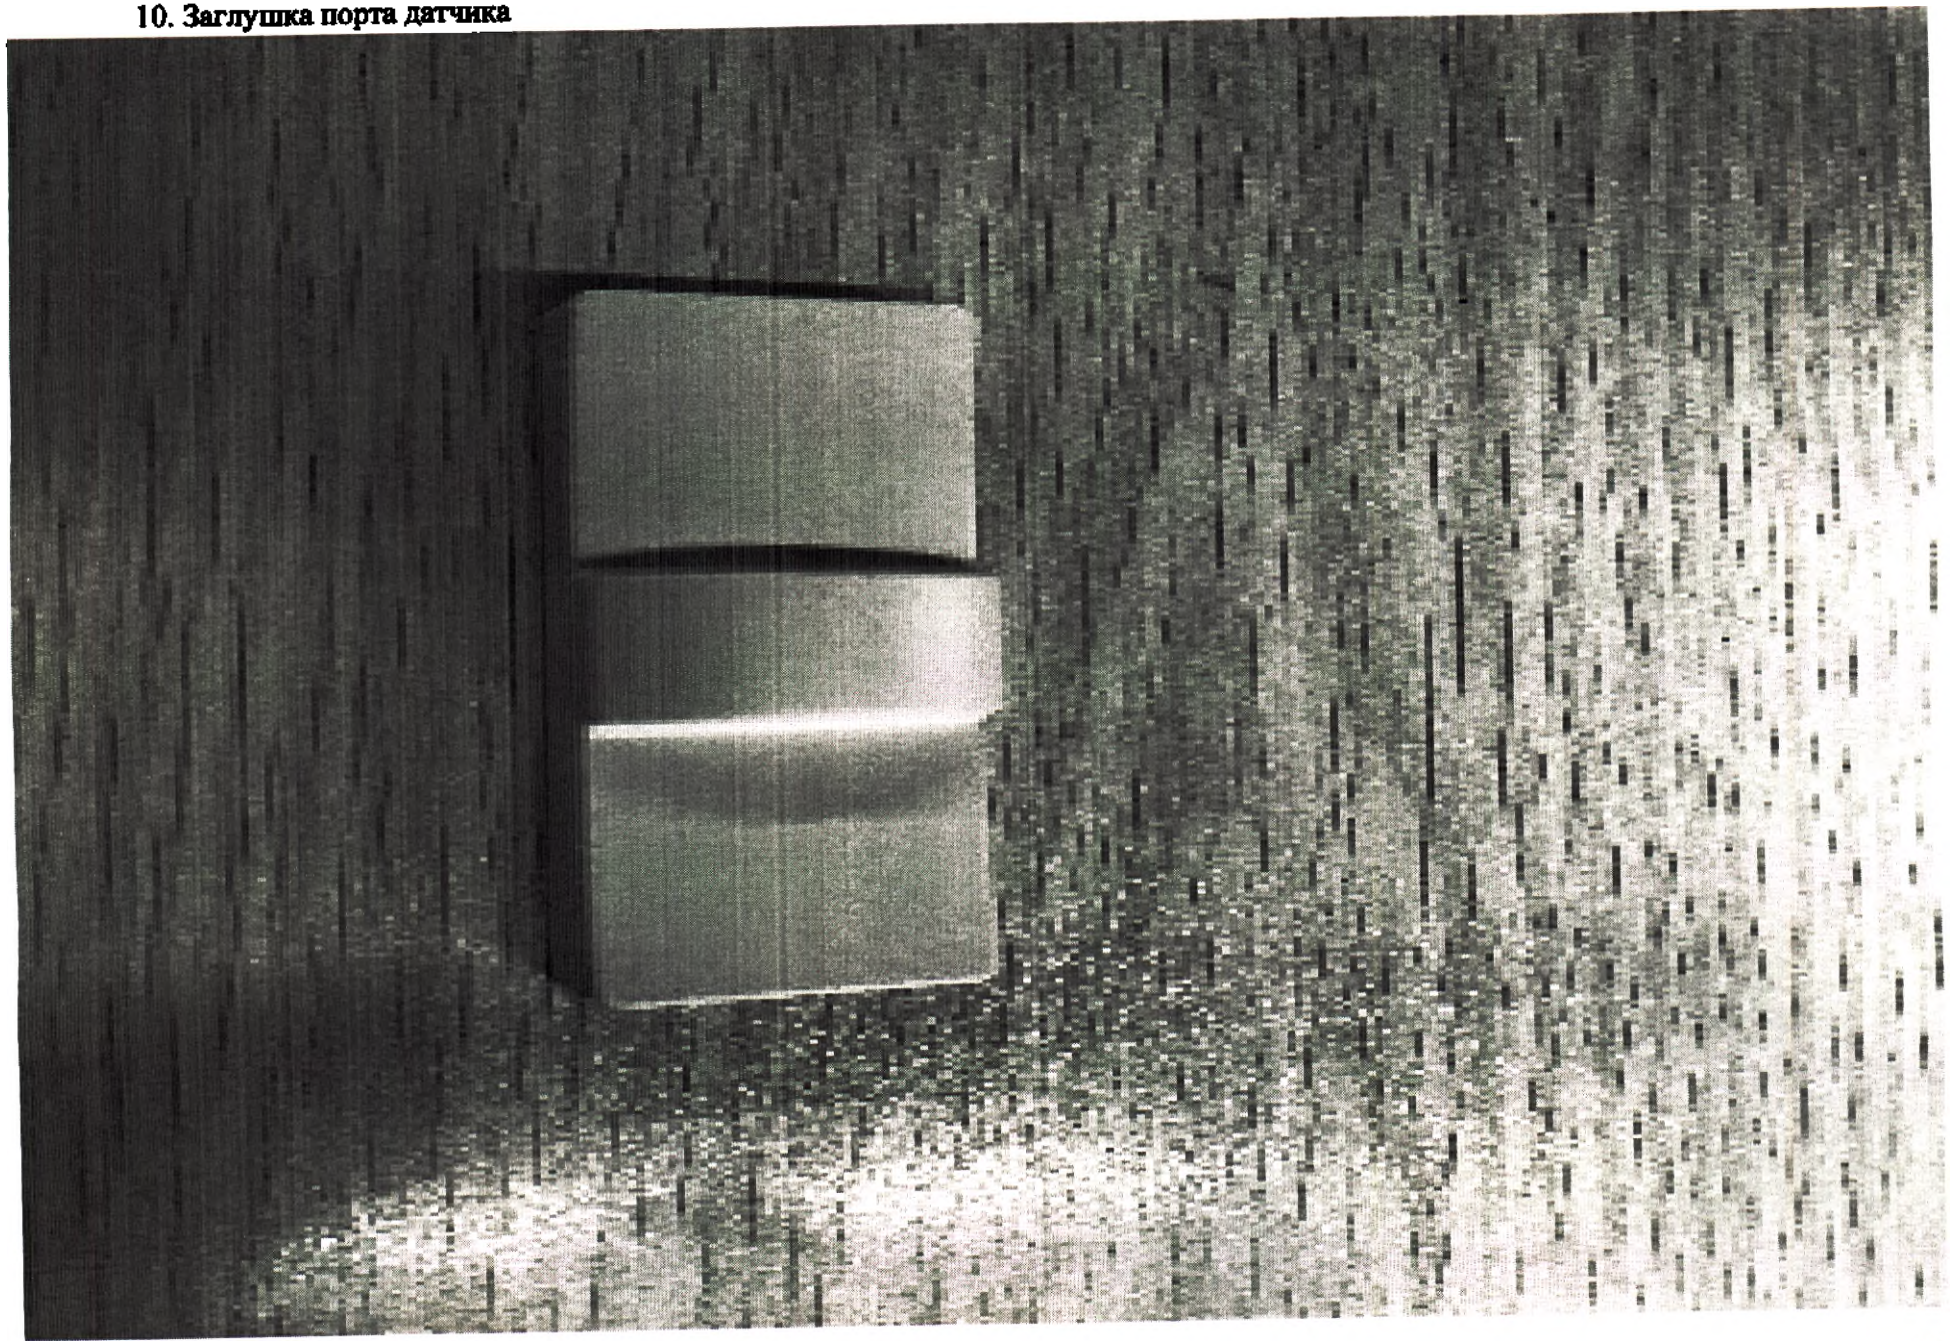


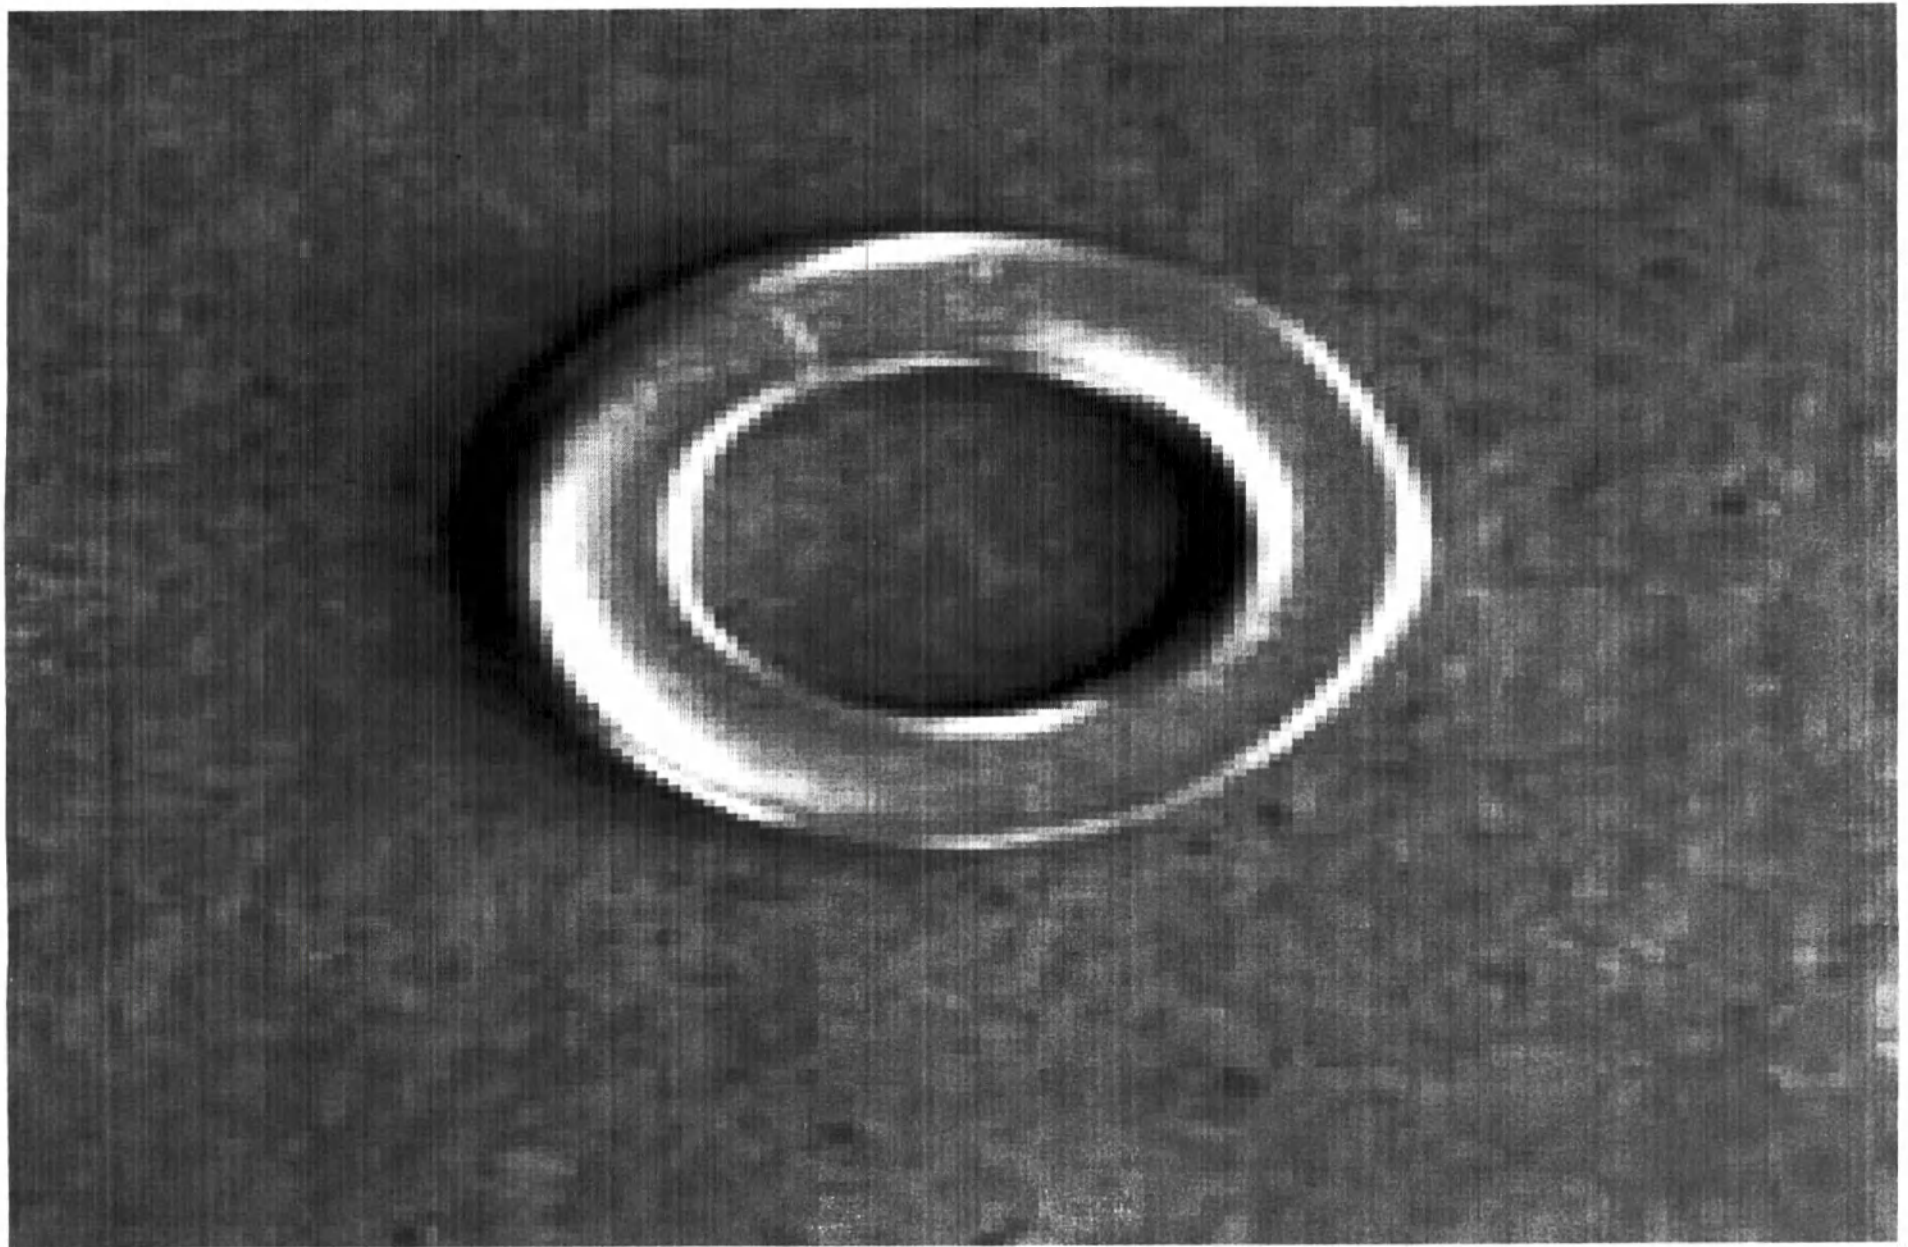


12. Шайба гроверная (пружинная)

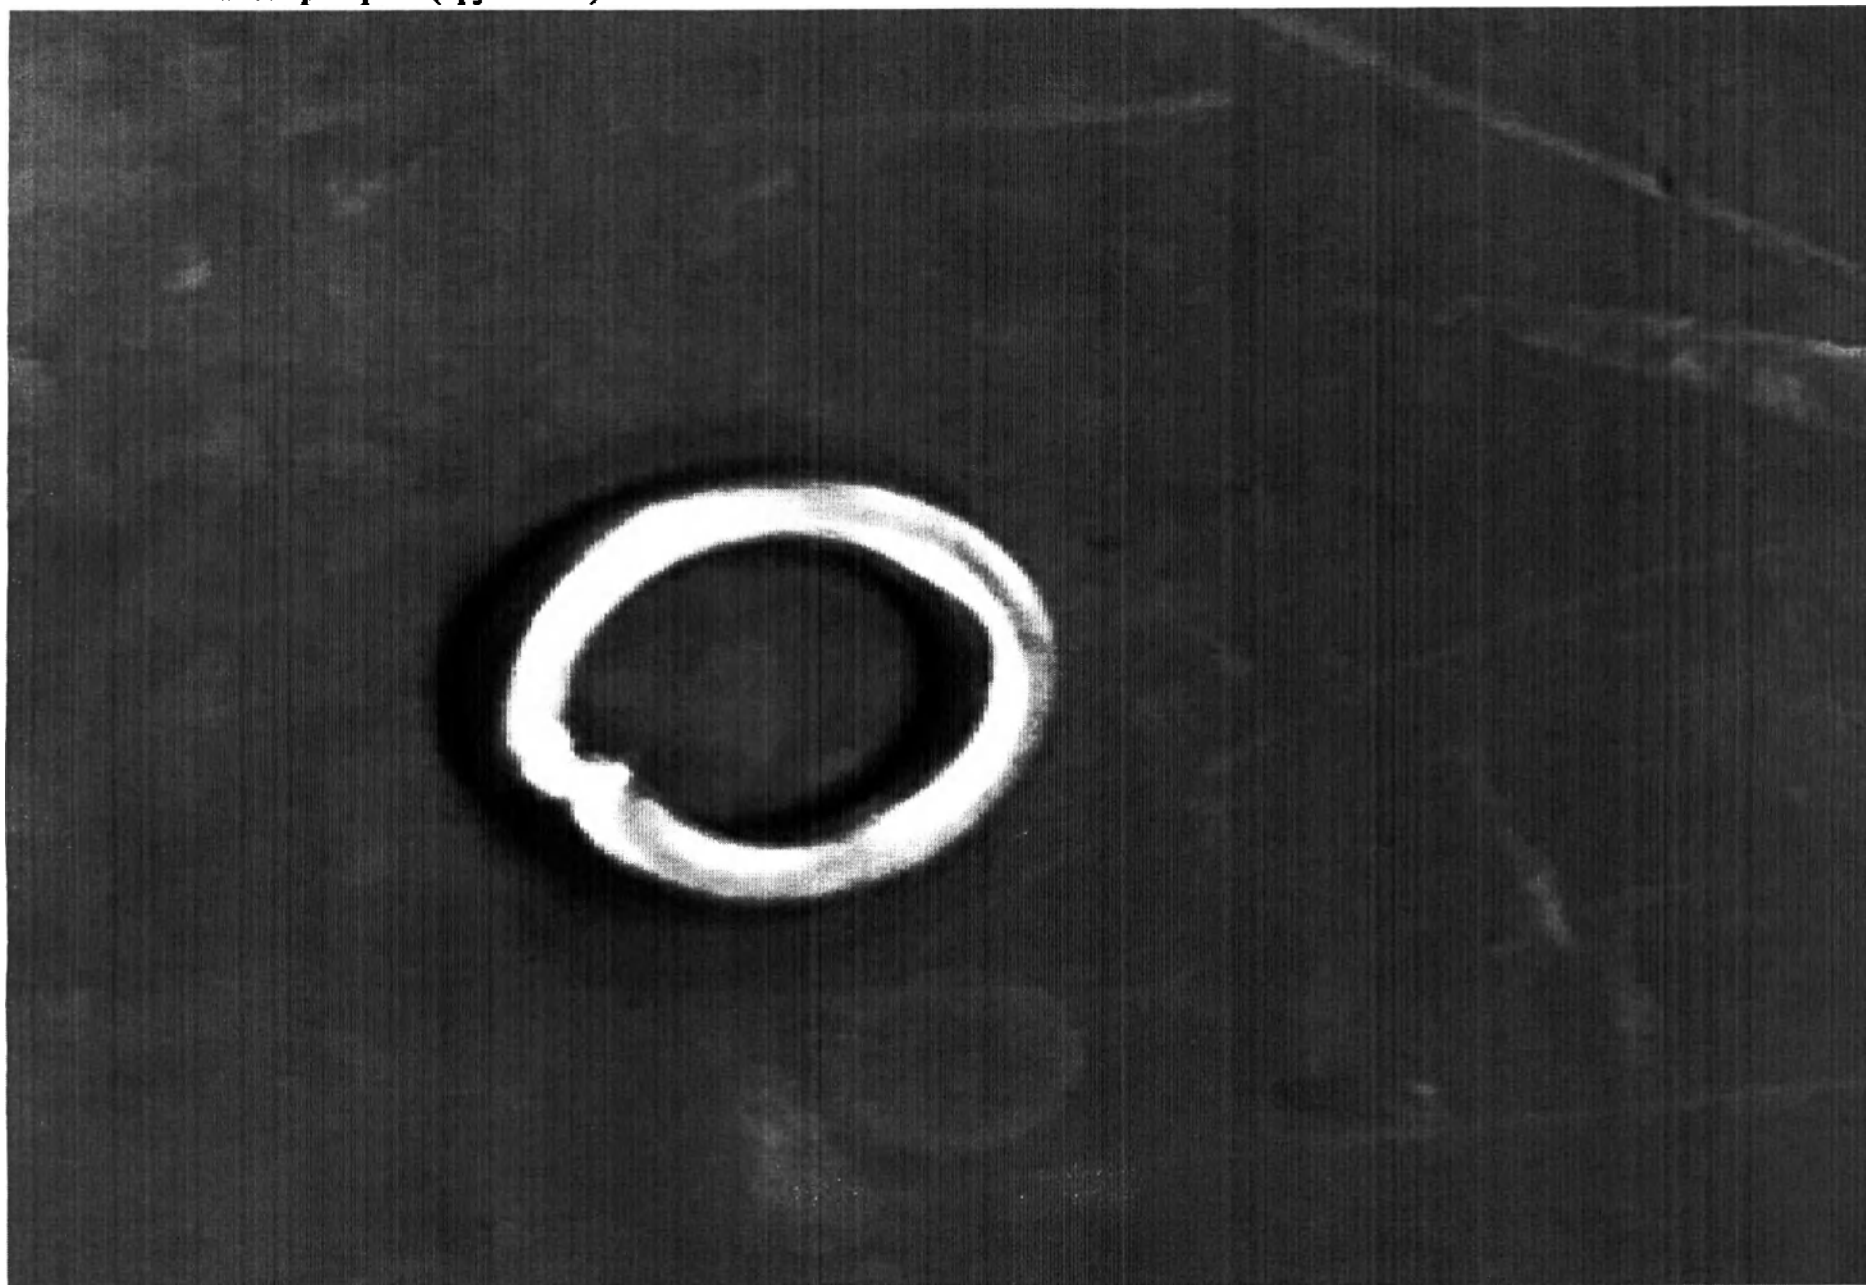

13. Винт с головкой под шестигранный ключ

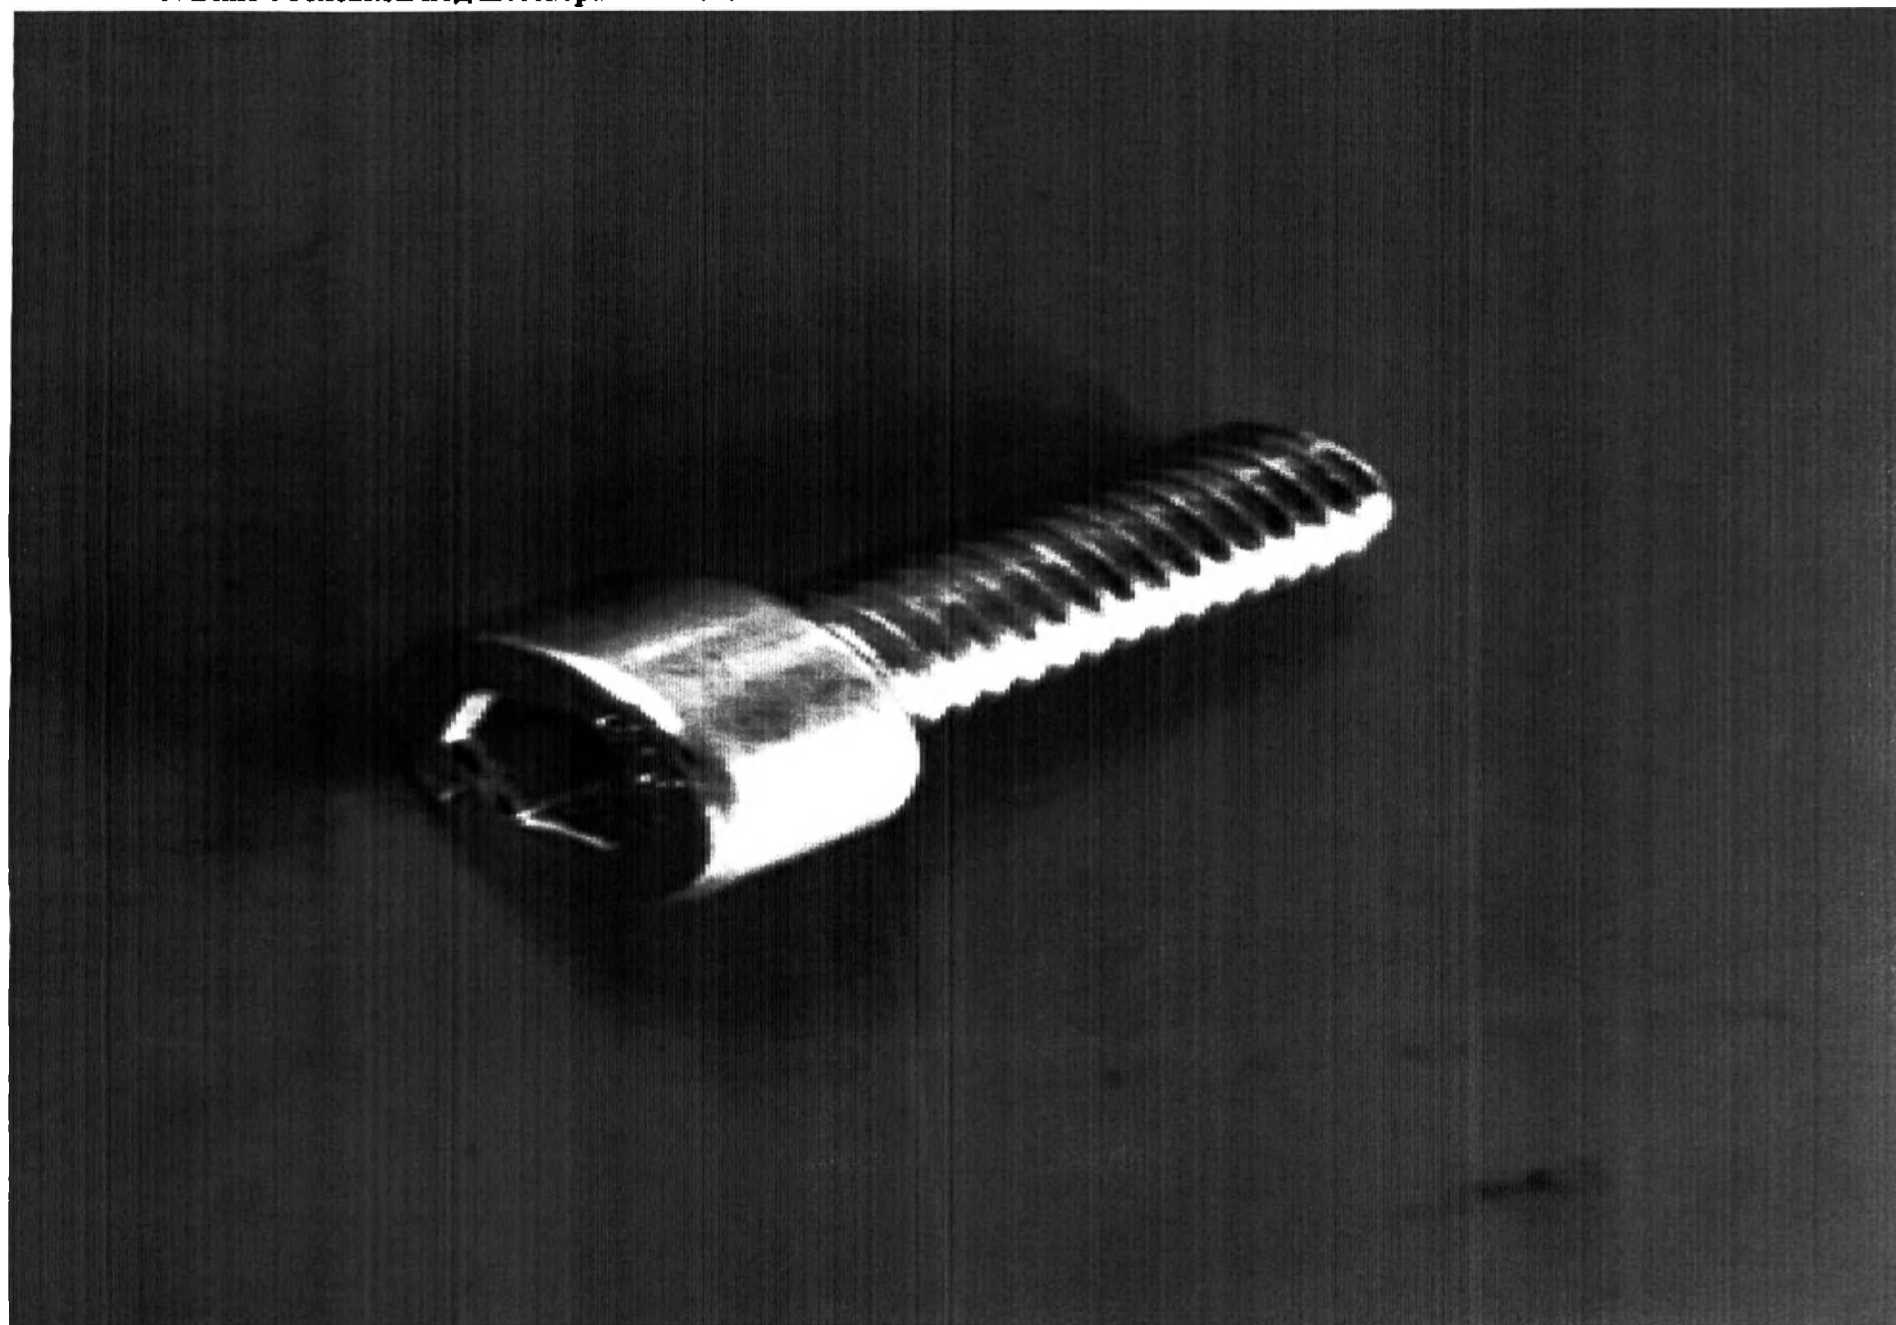


14. Крепления для адаптера

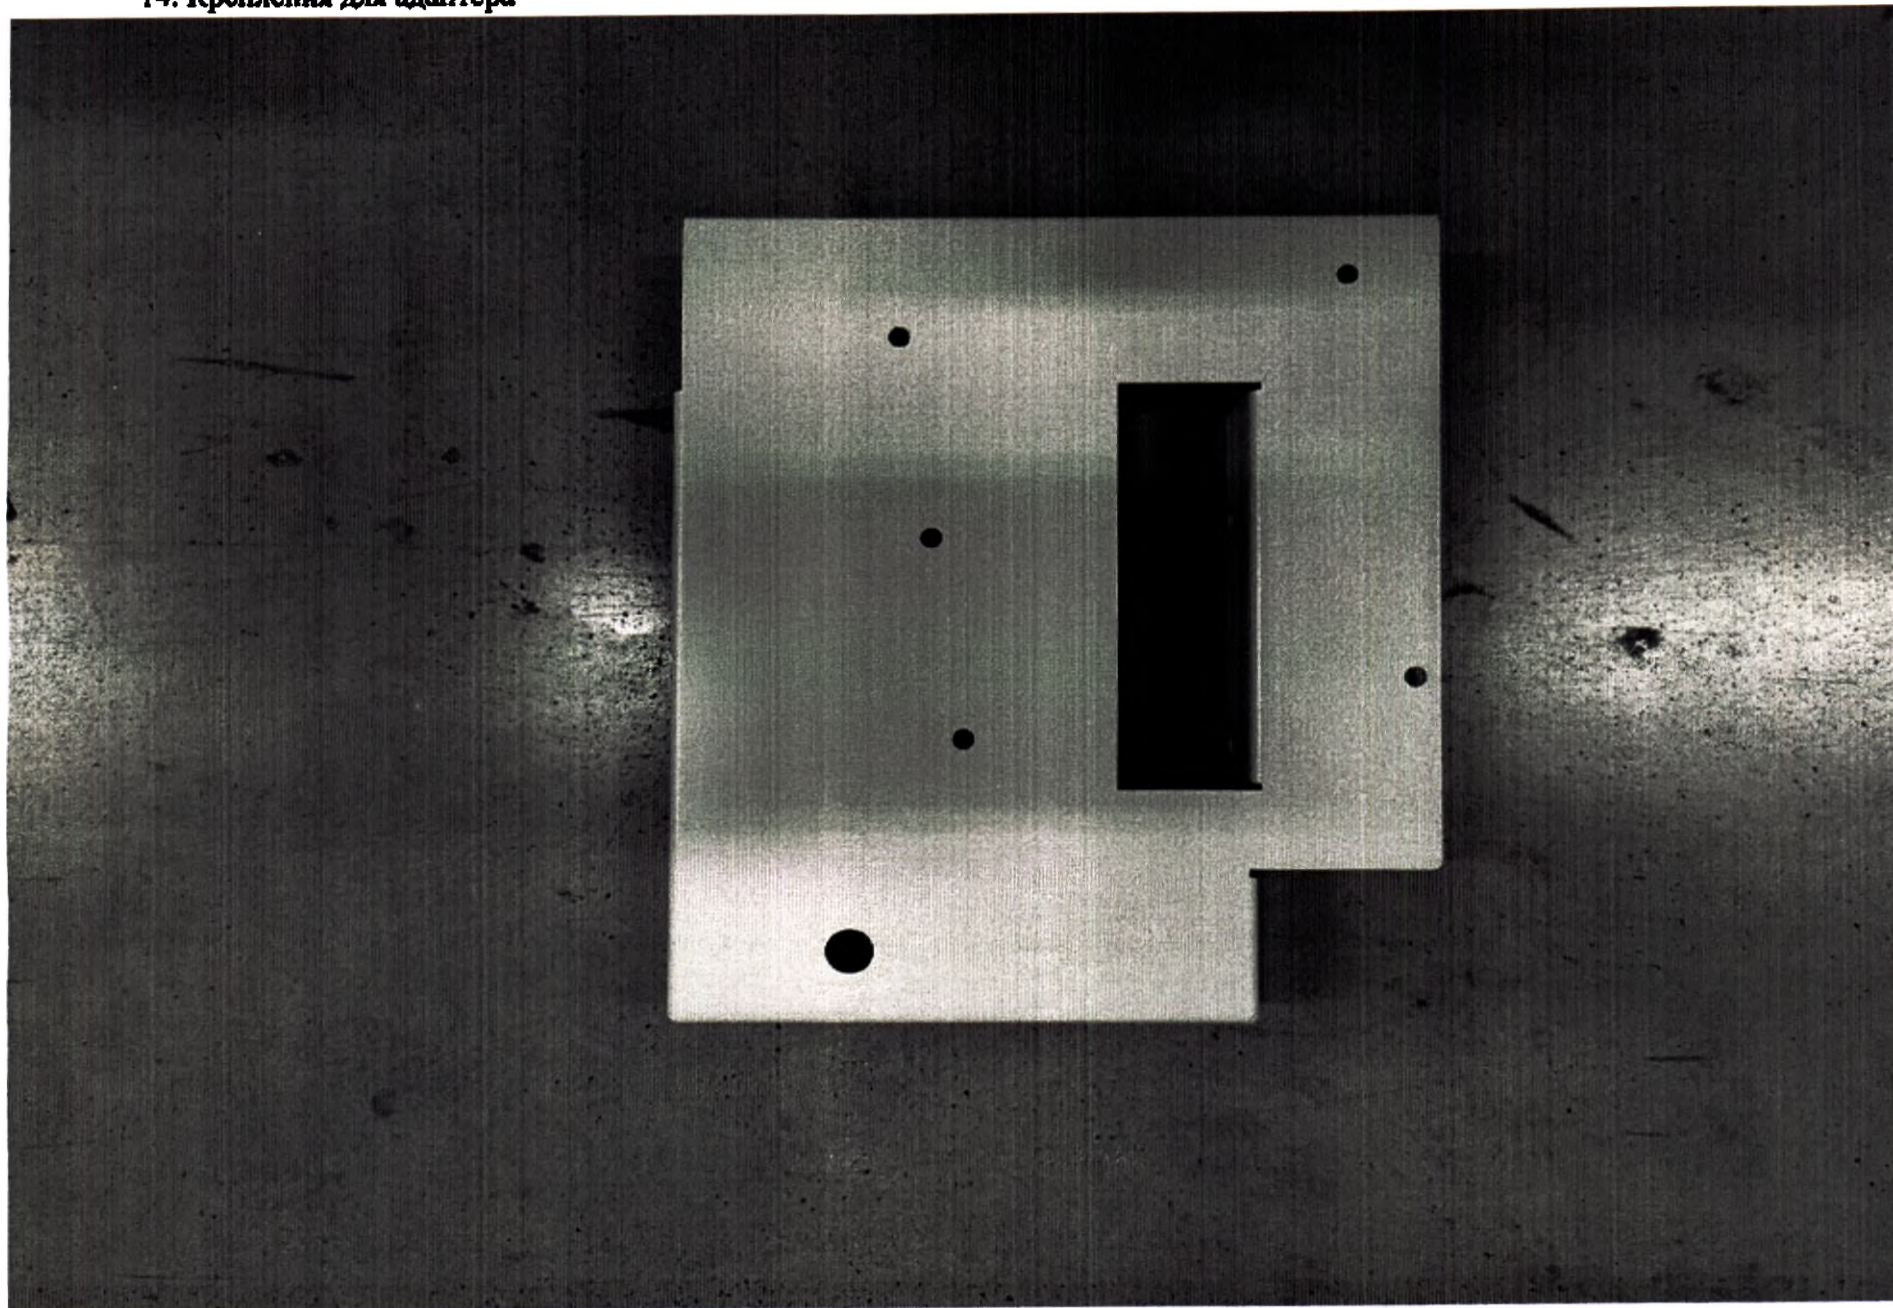


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку




16. Беспроводной USB-адаптер

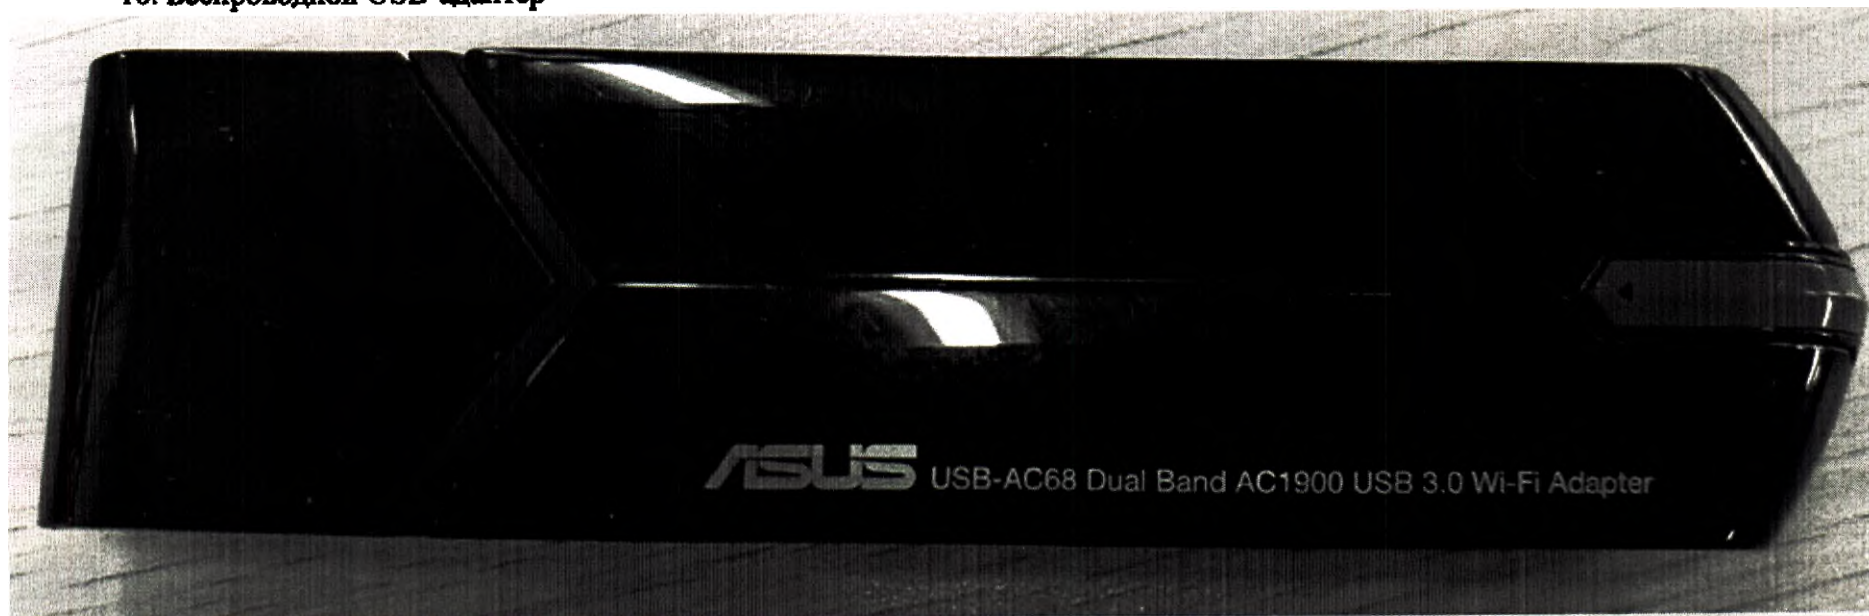


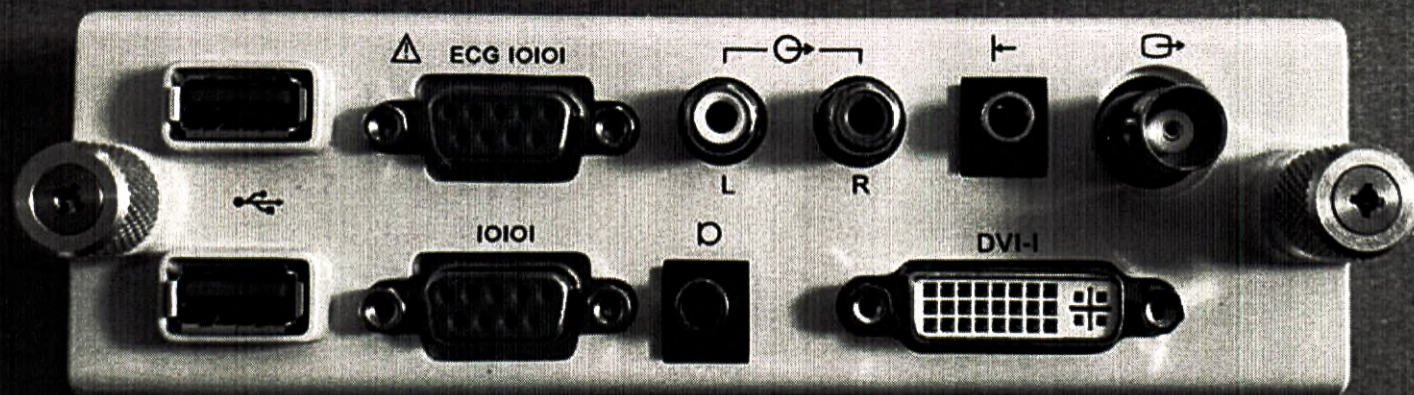

18. Кабель BNC




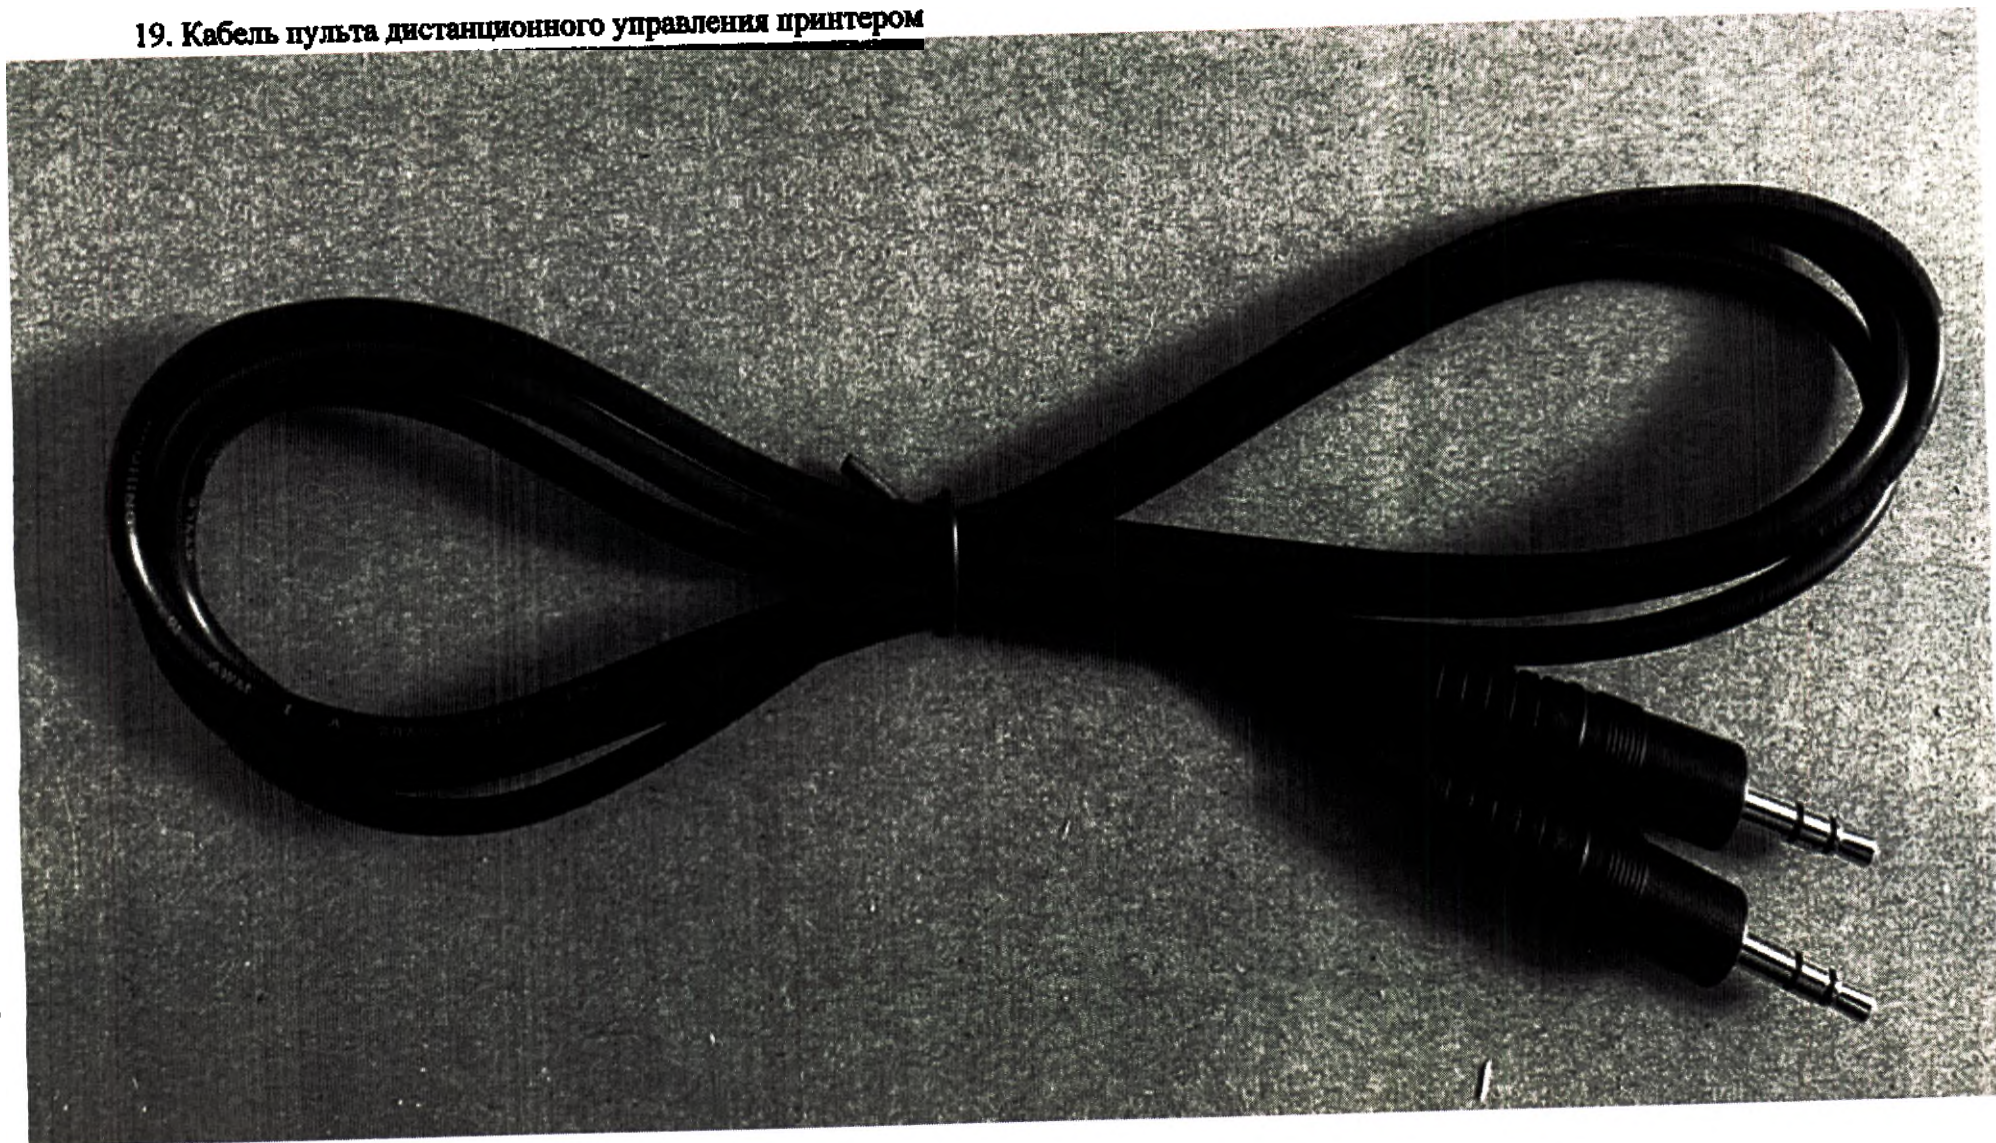

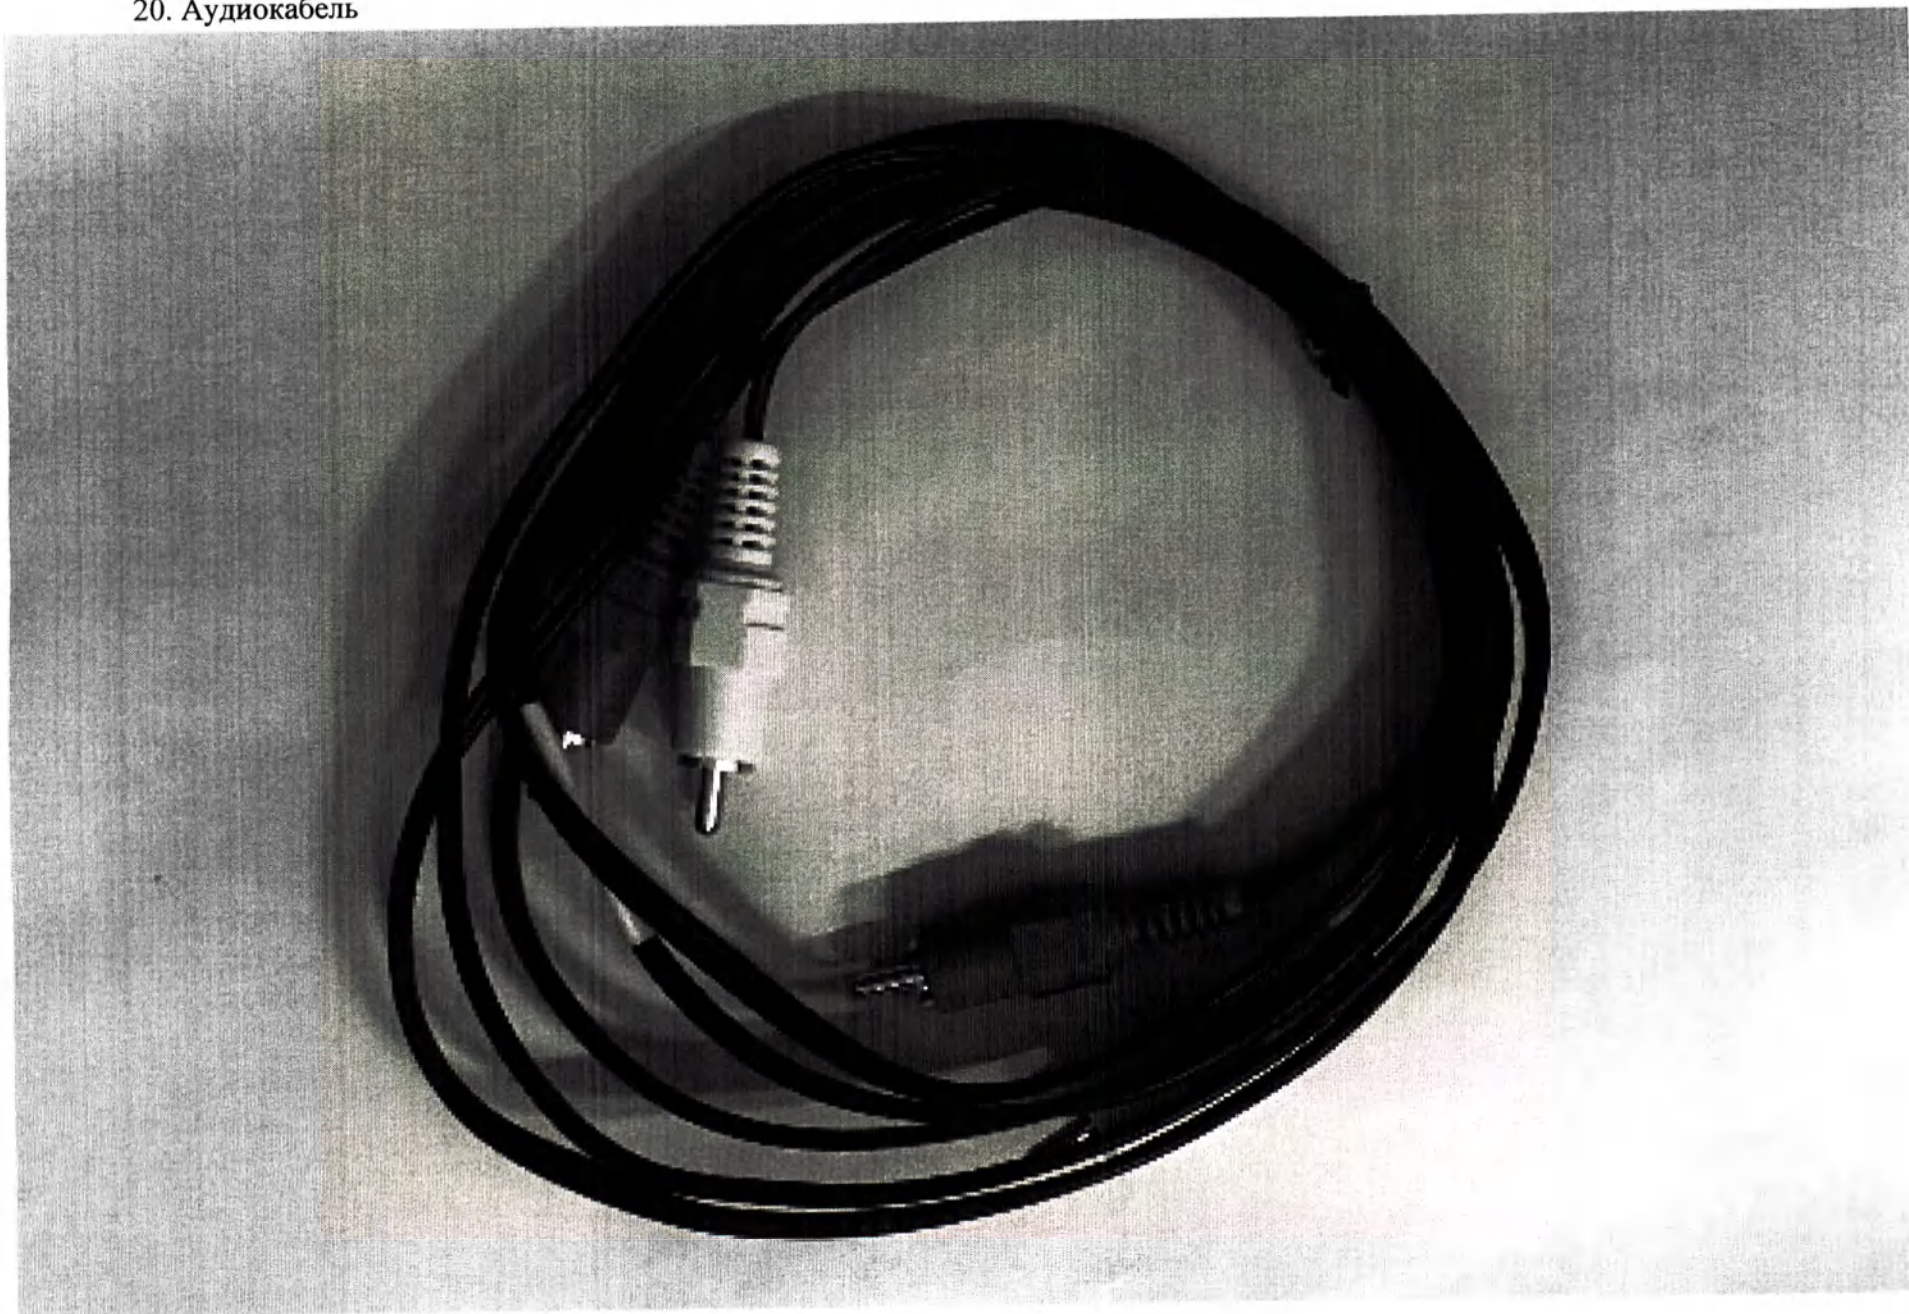




22. Накладка на панель управления защитная

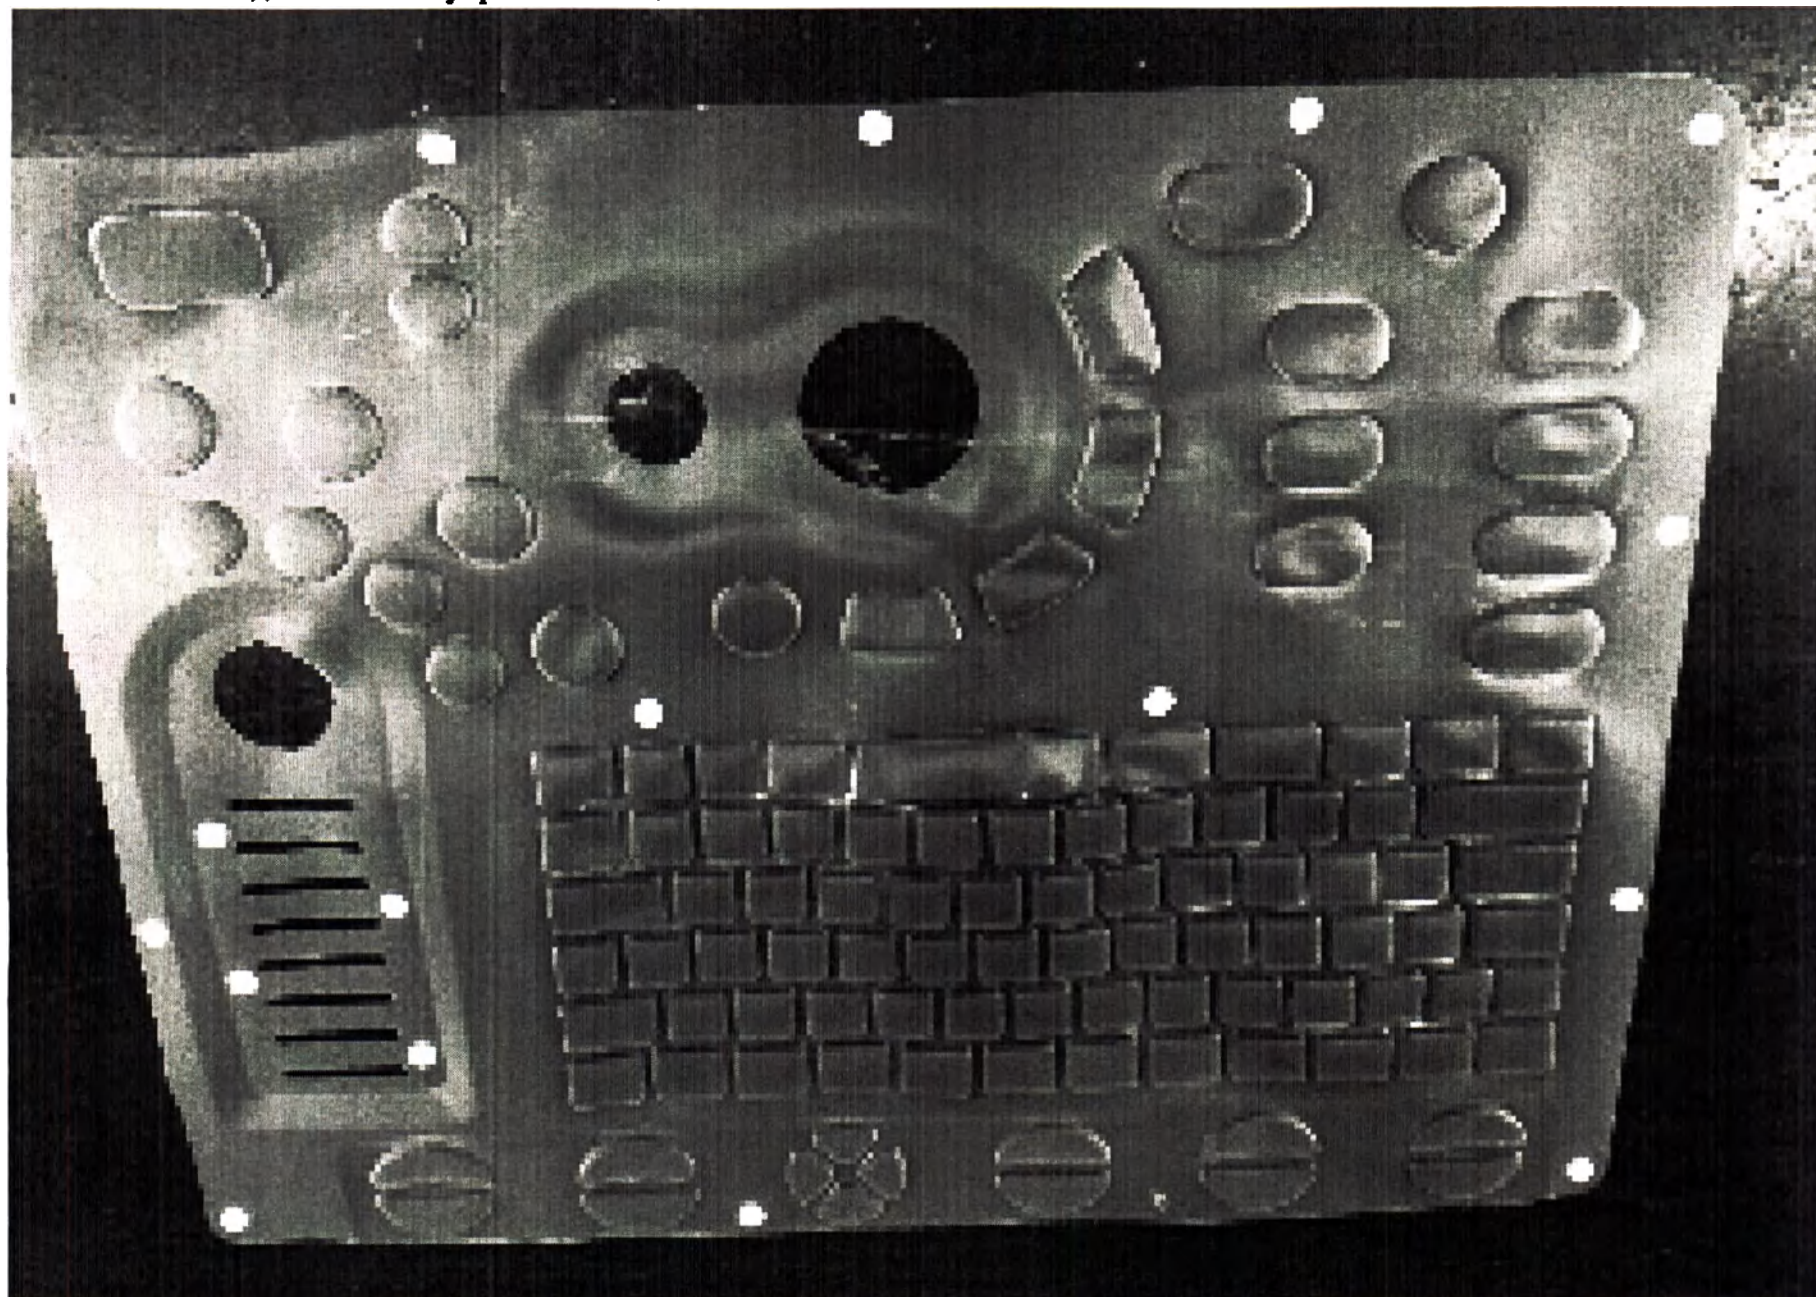



24. Датчики ультразвуковые

24.1. Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s

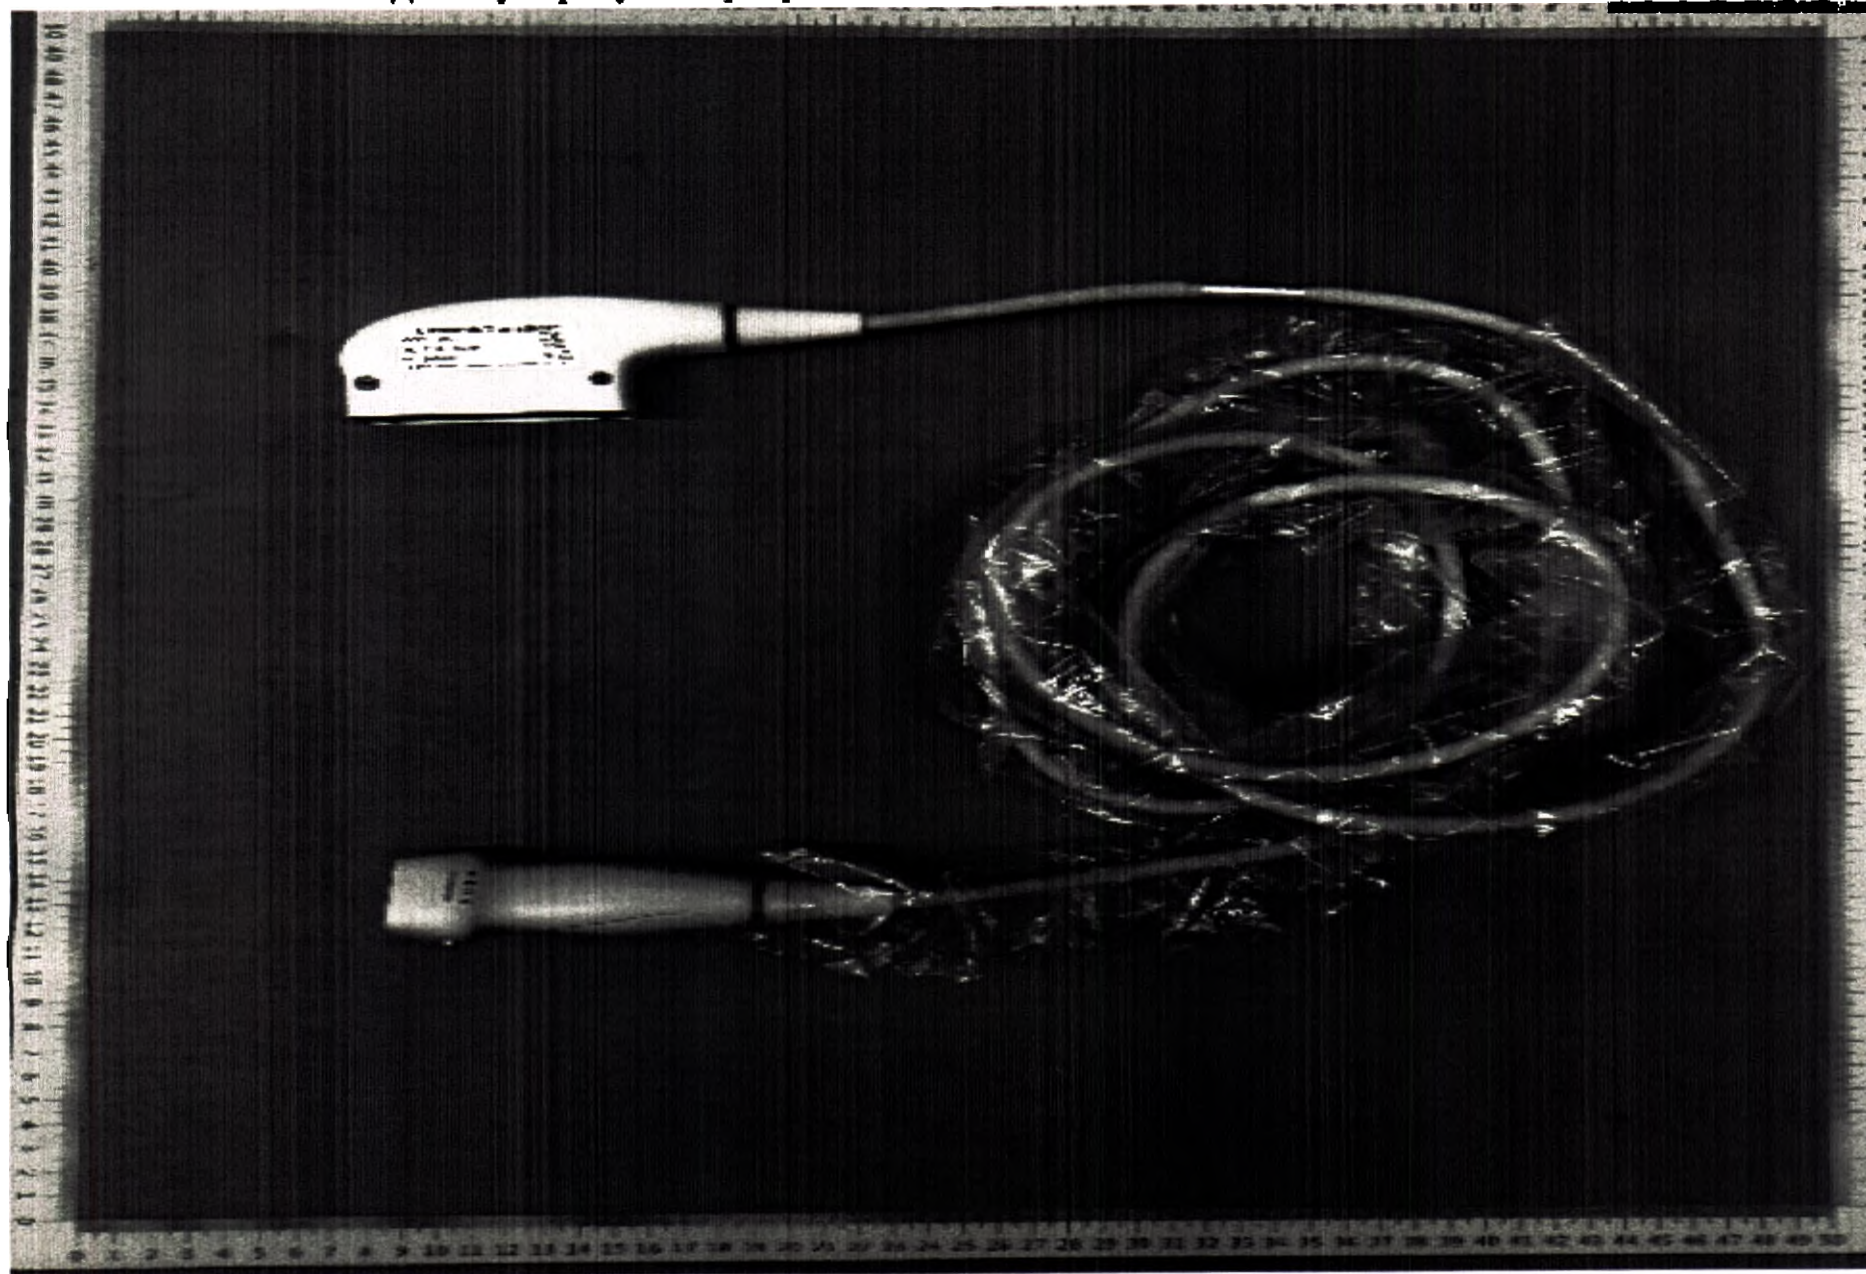


24.2. Датчик ультразвуковой конвексный 3С5s



24.3. Датчик ультразвуковой конвексный объемный 4CD4s




24.4. Датчик ультразвуковой микроконвексный 6C2s

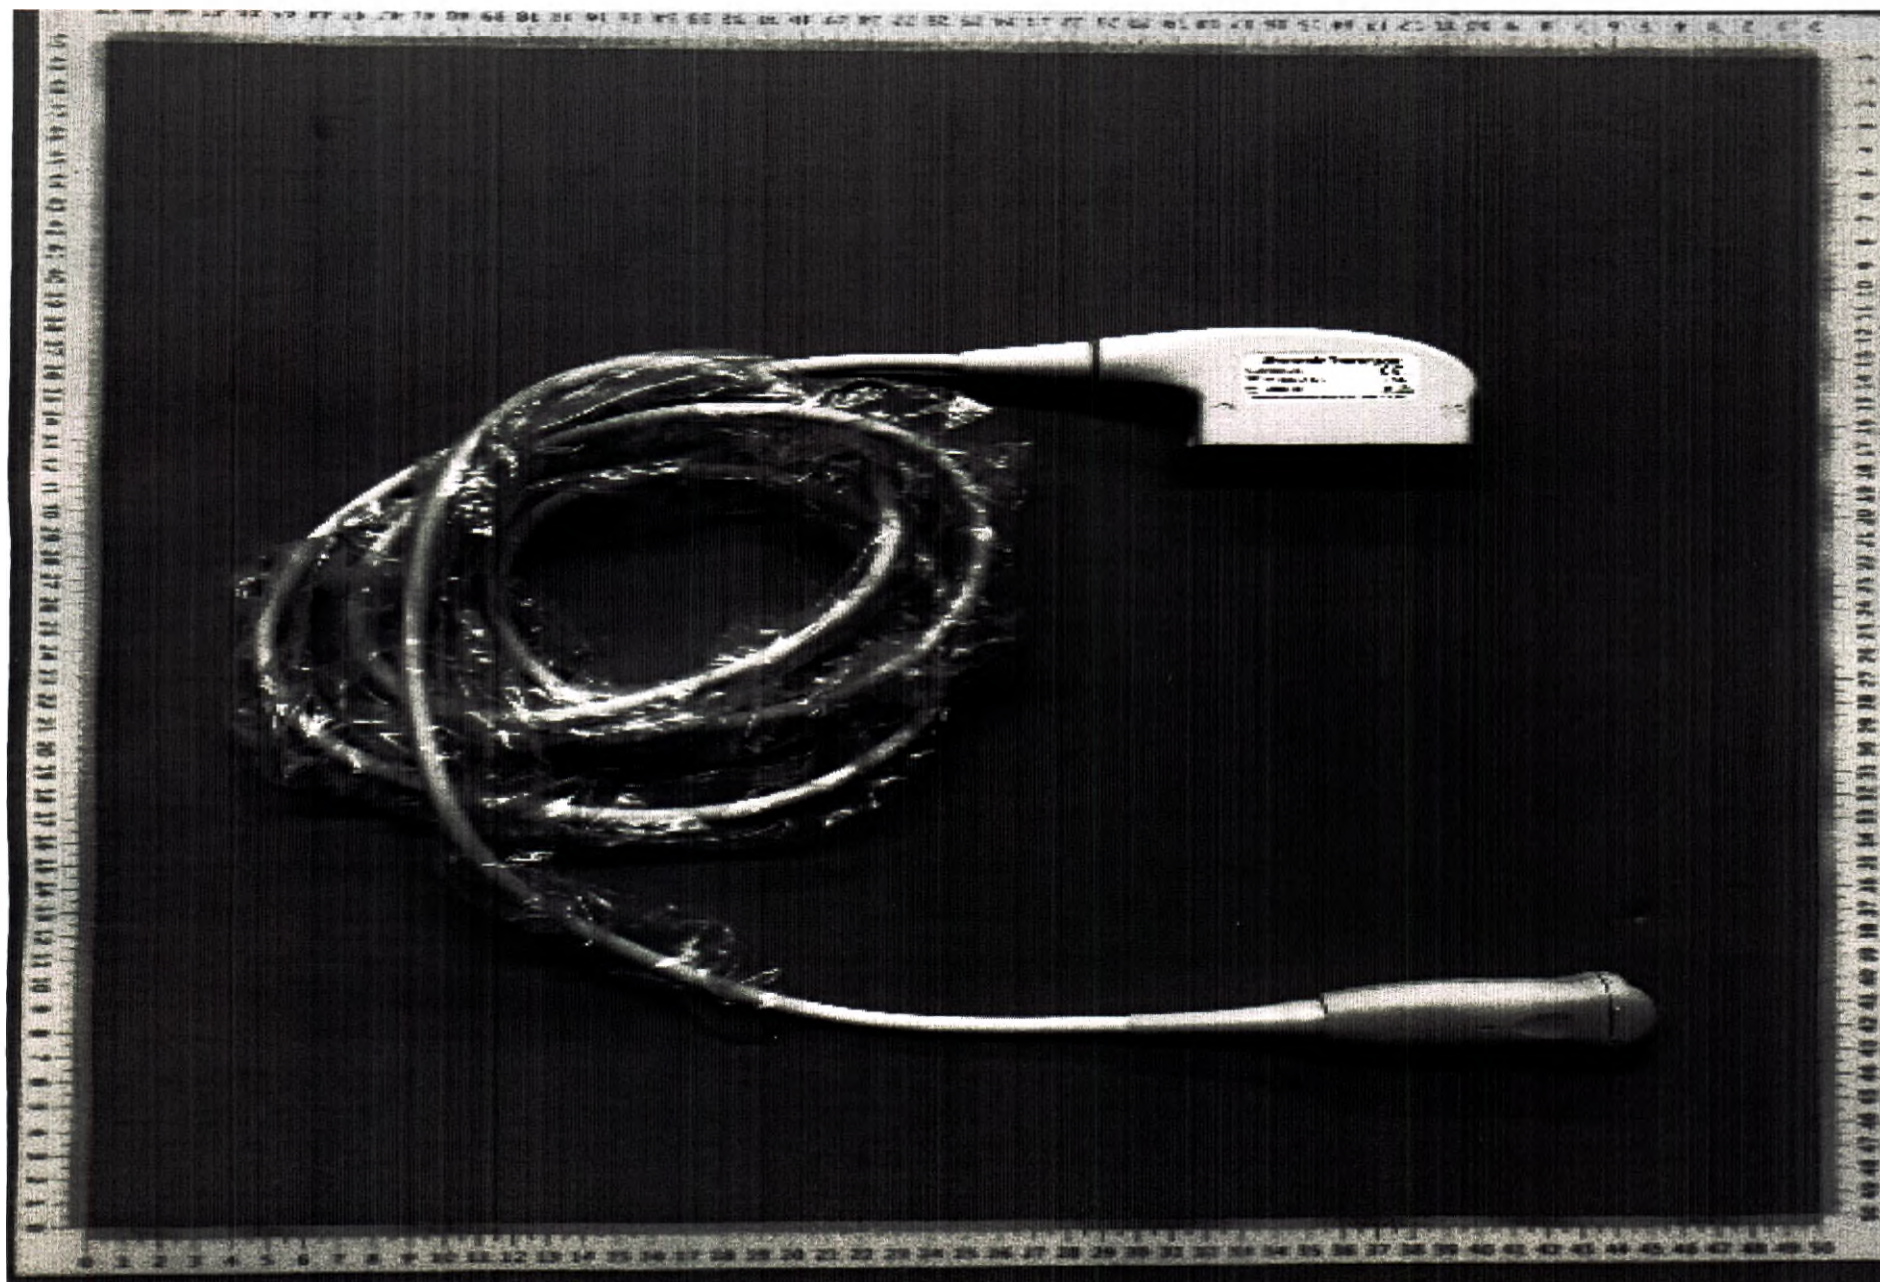

24.5. Датчик ультразвуковой конвексный внутриполостной 6CV1s




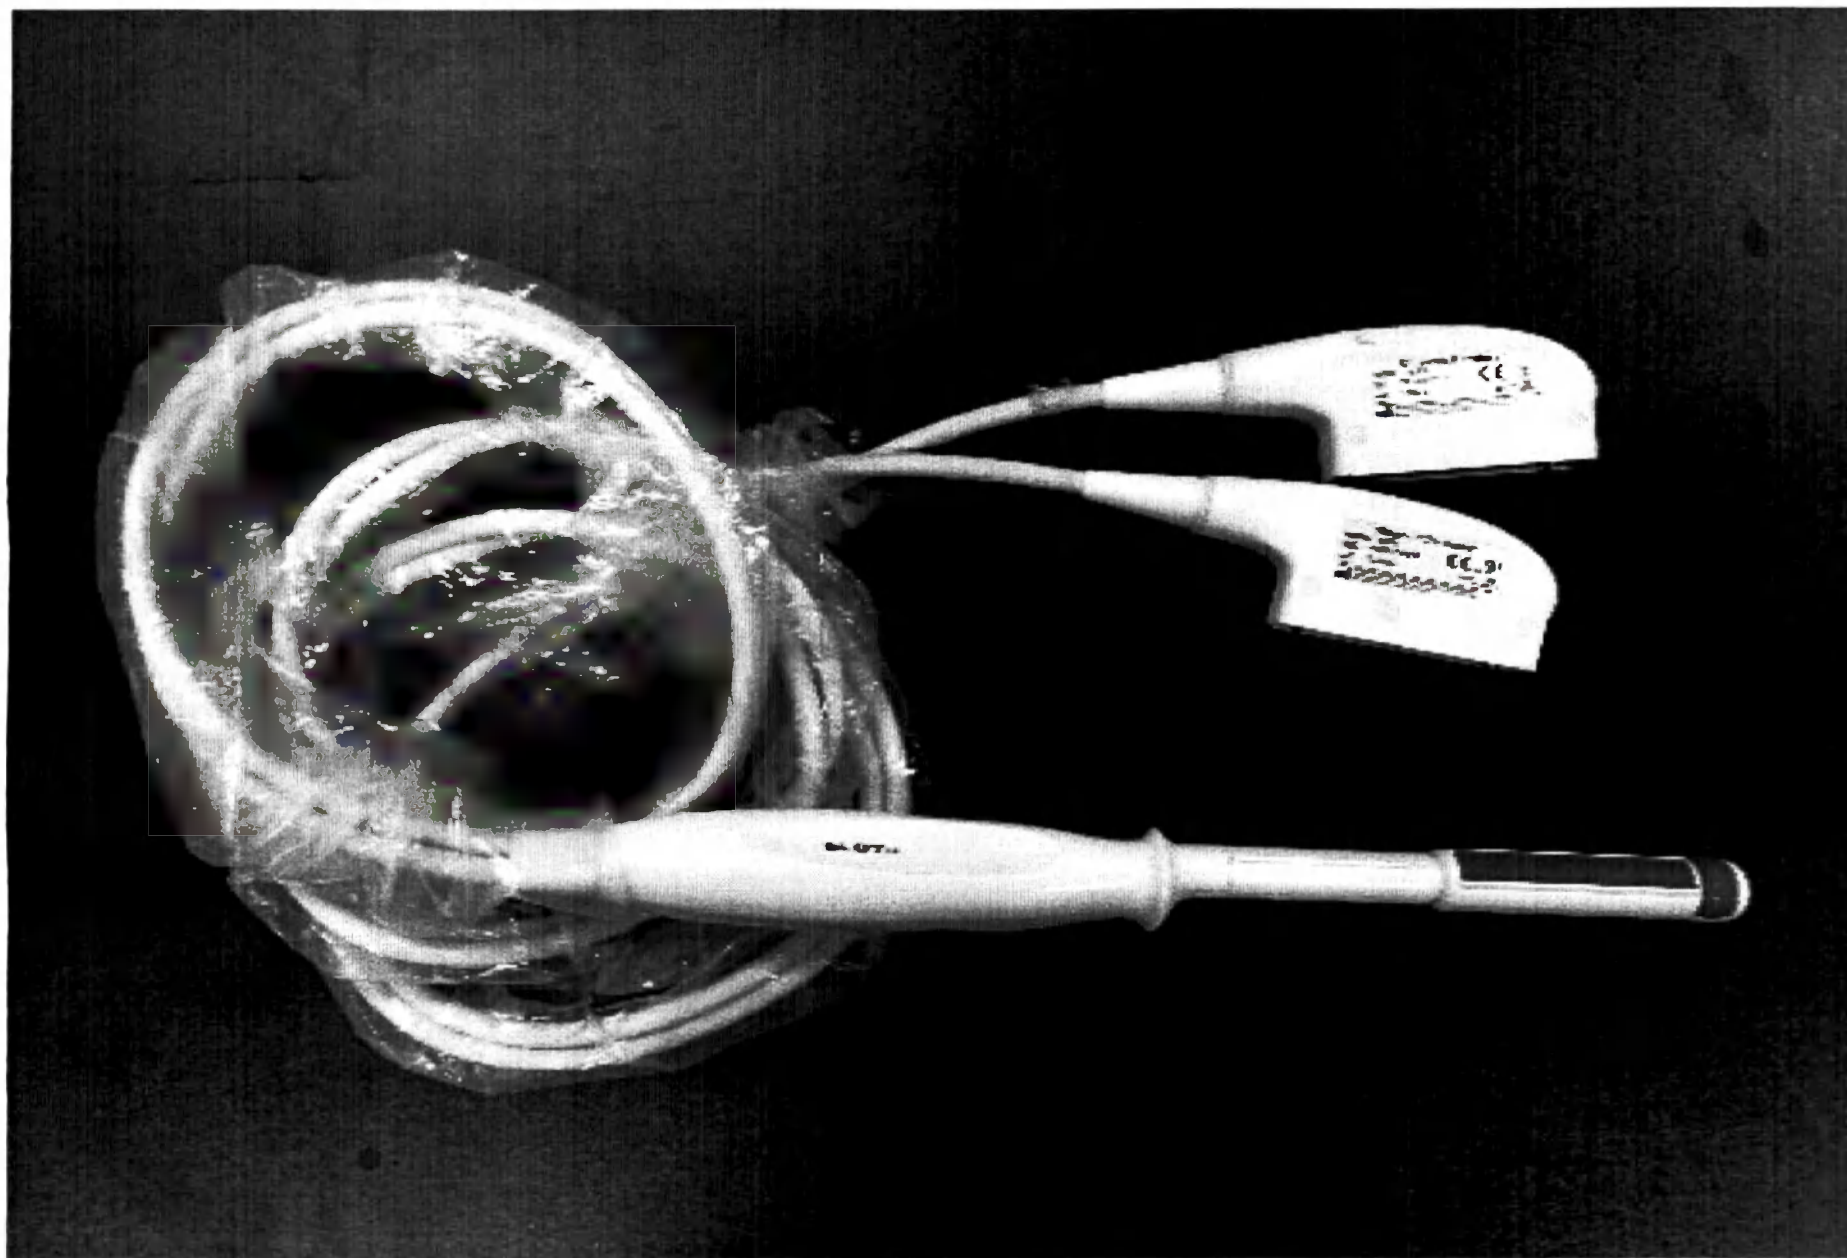








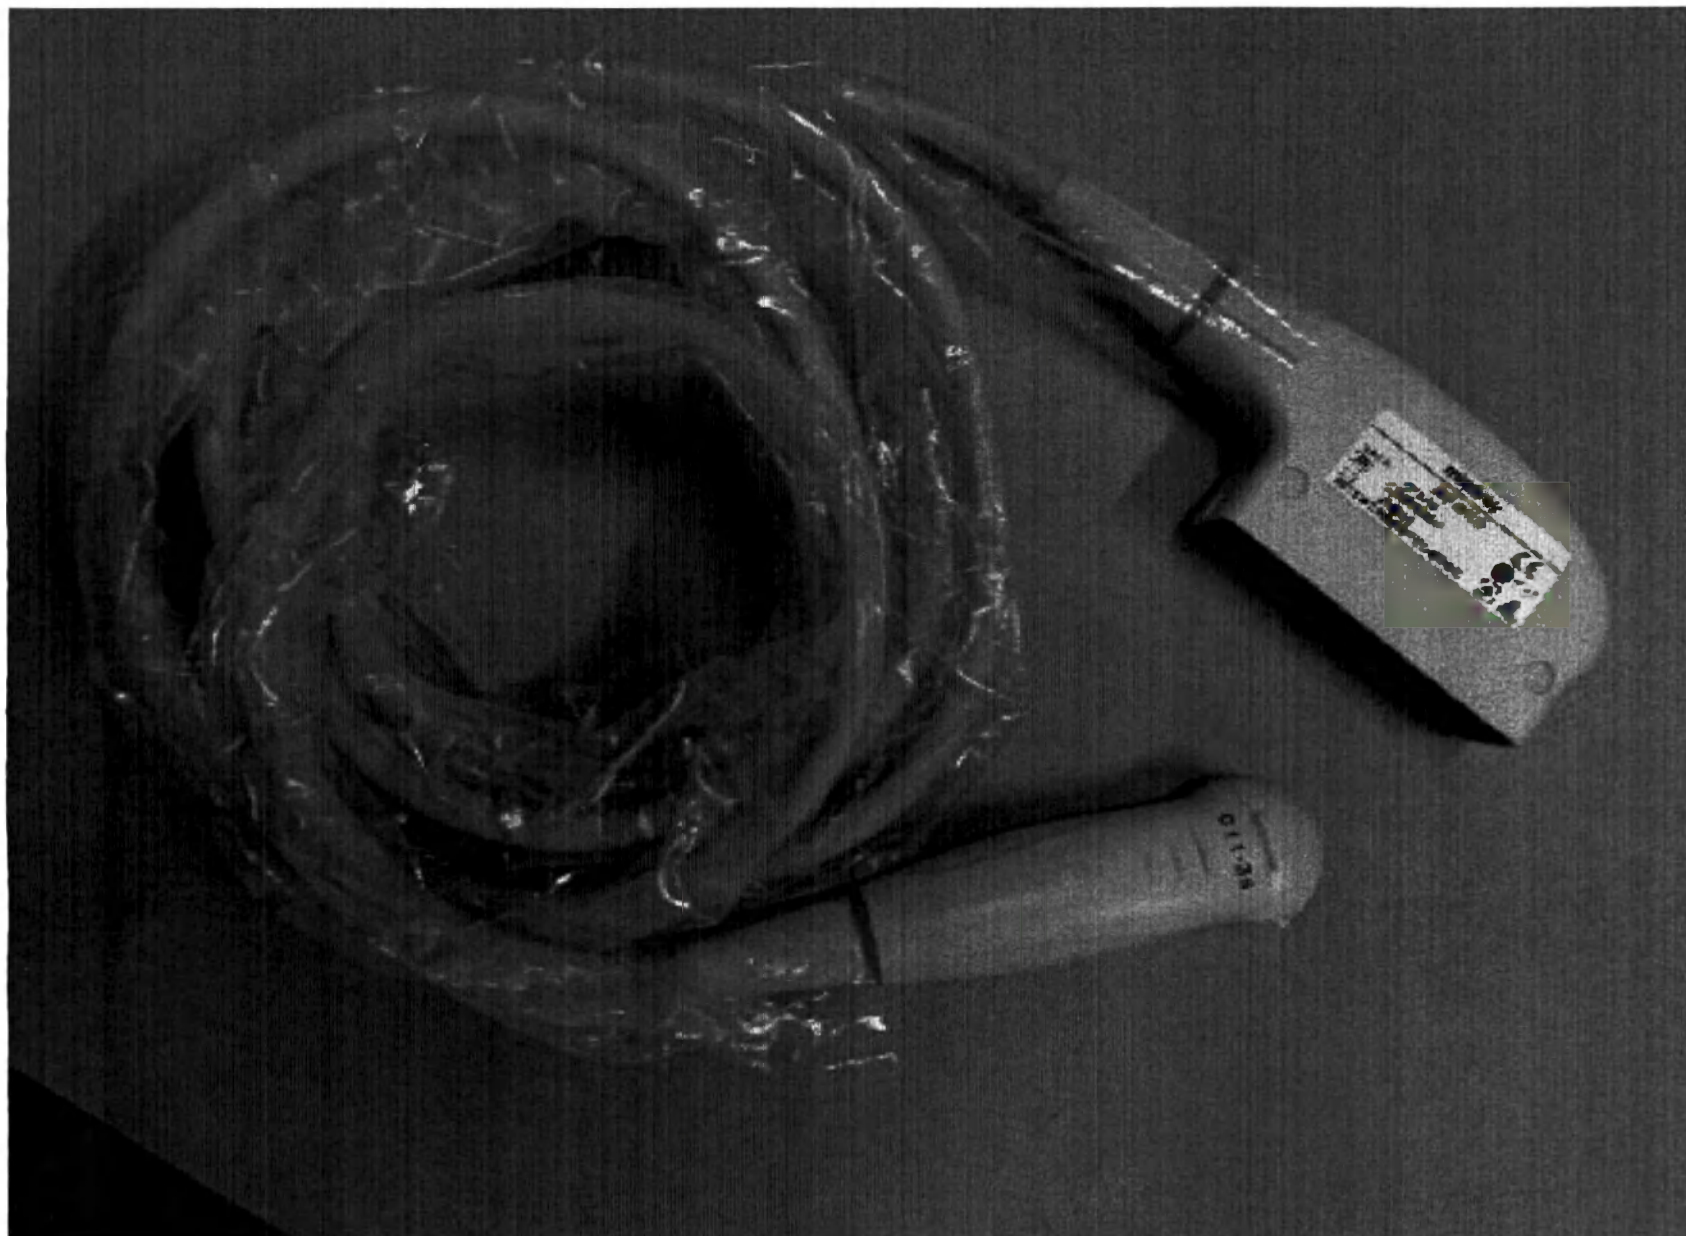





24.12. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2s

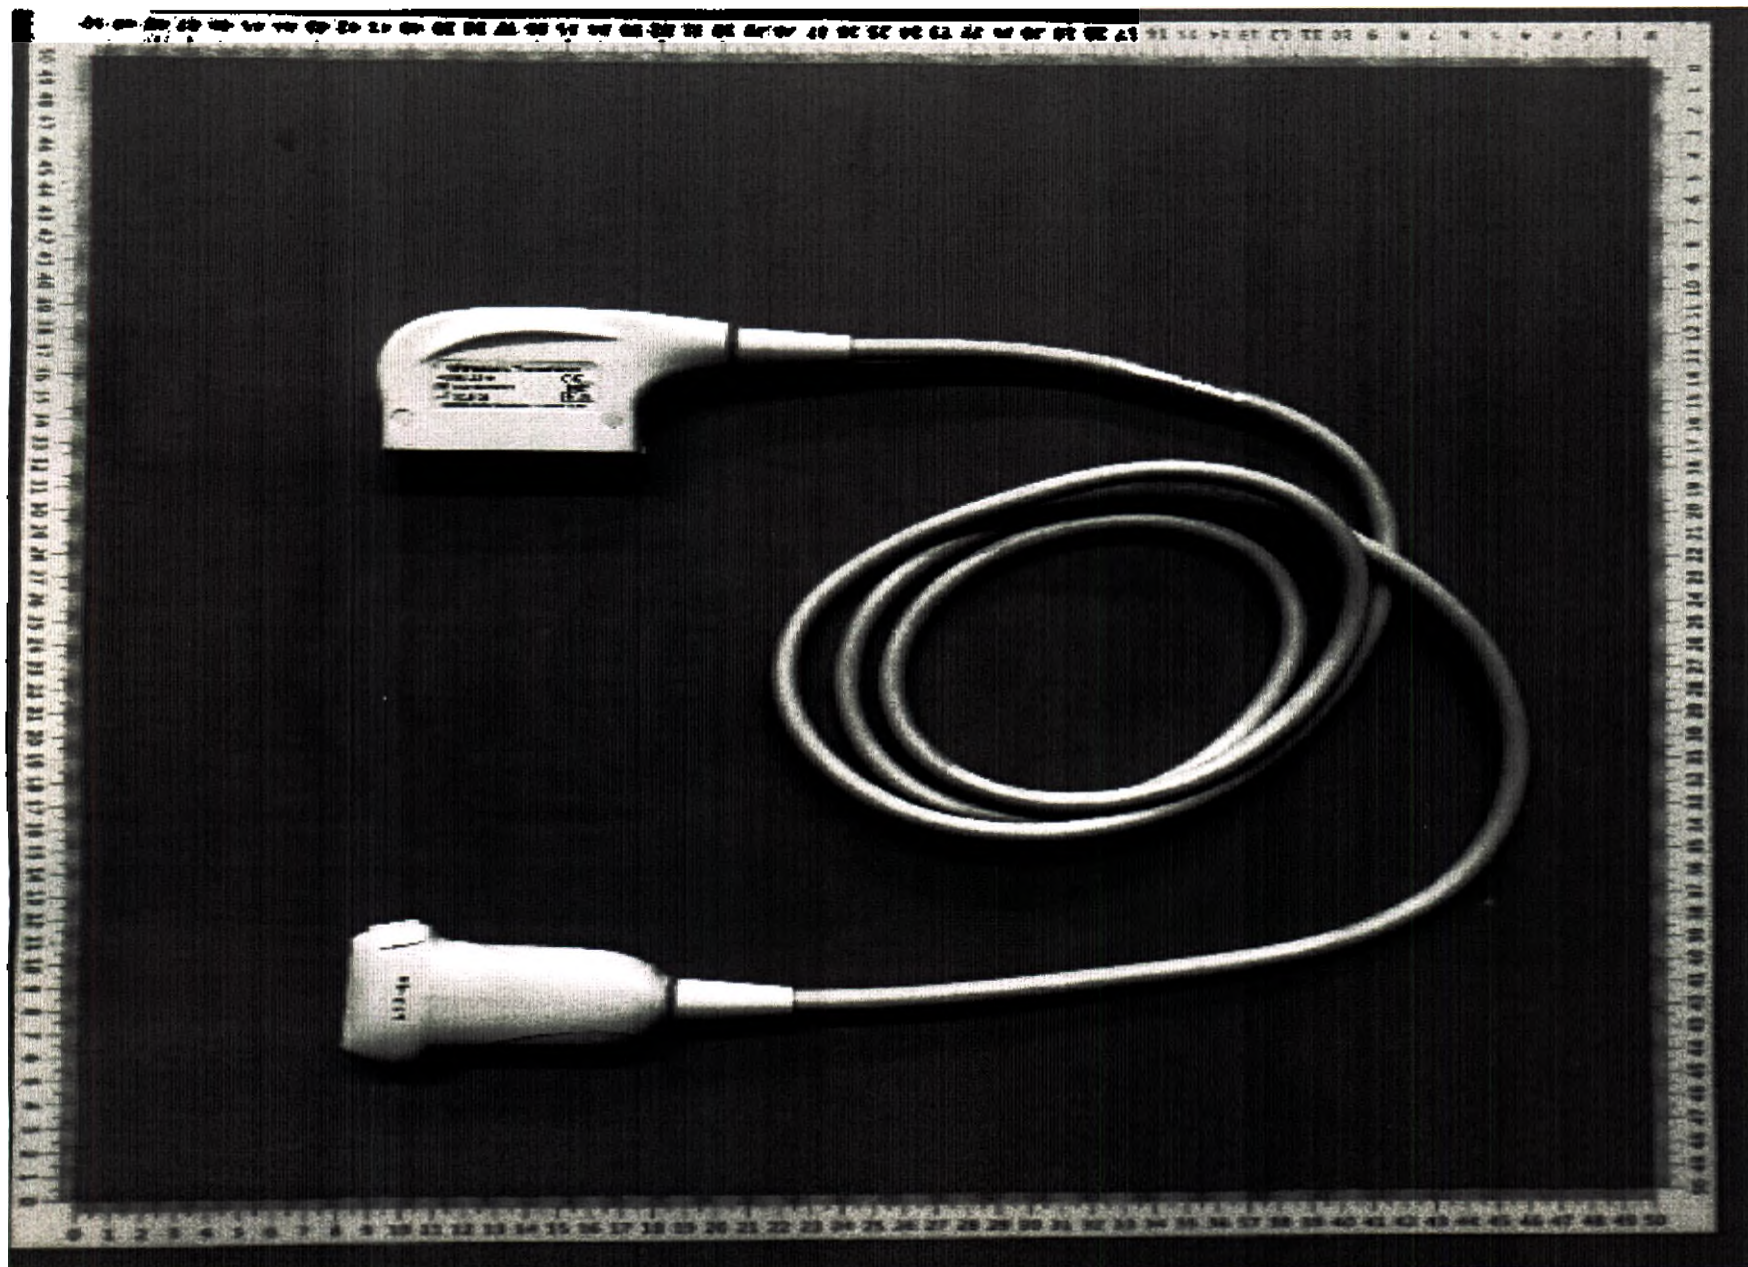


24.13. Датчик ультразвуковой линейный L12-4s

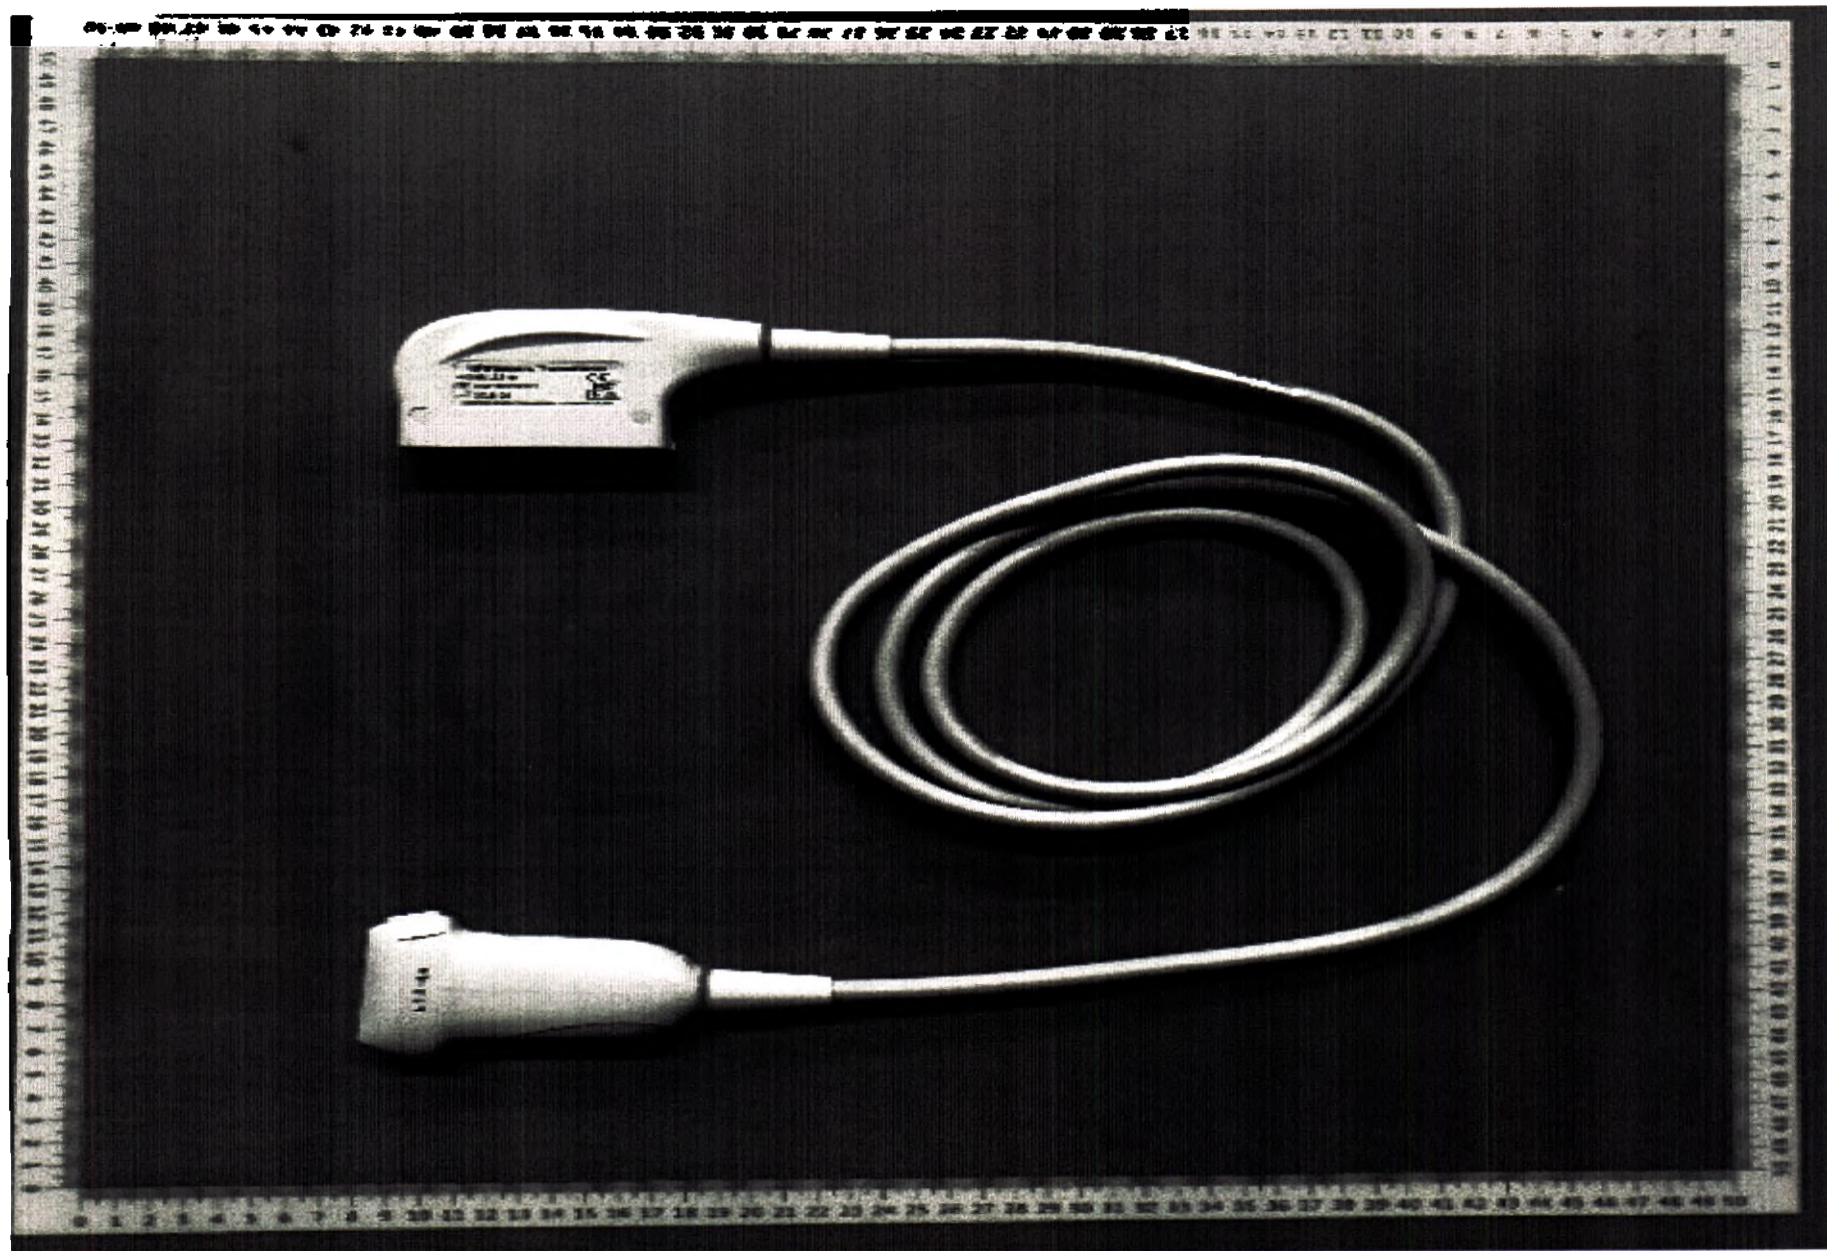

24.14. Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

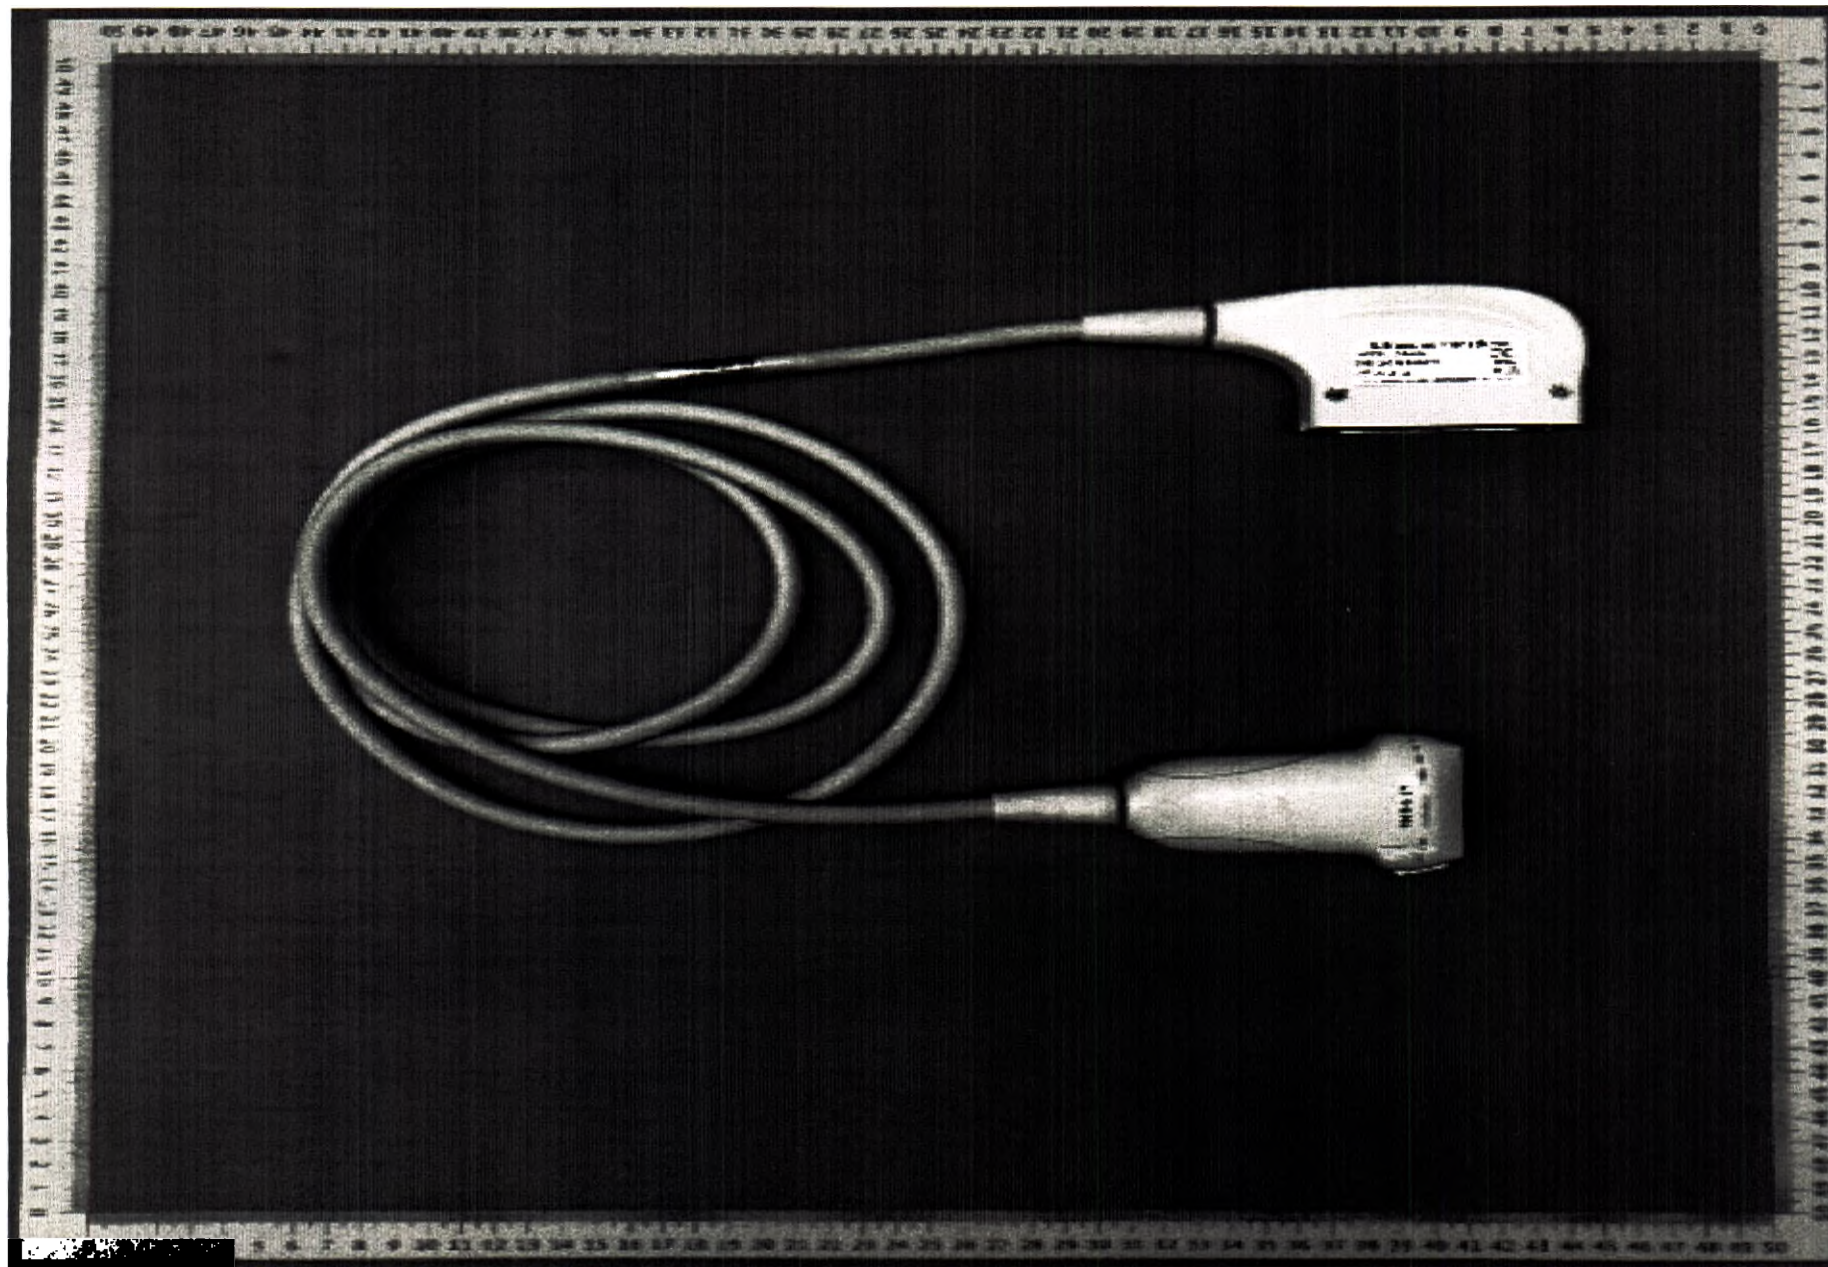




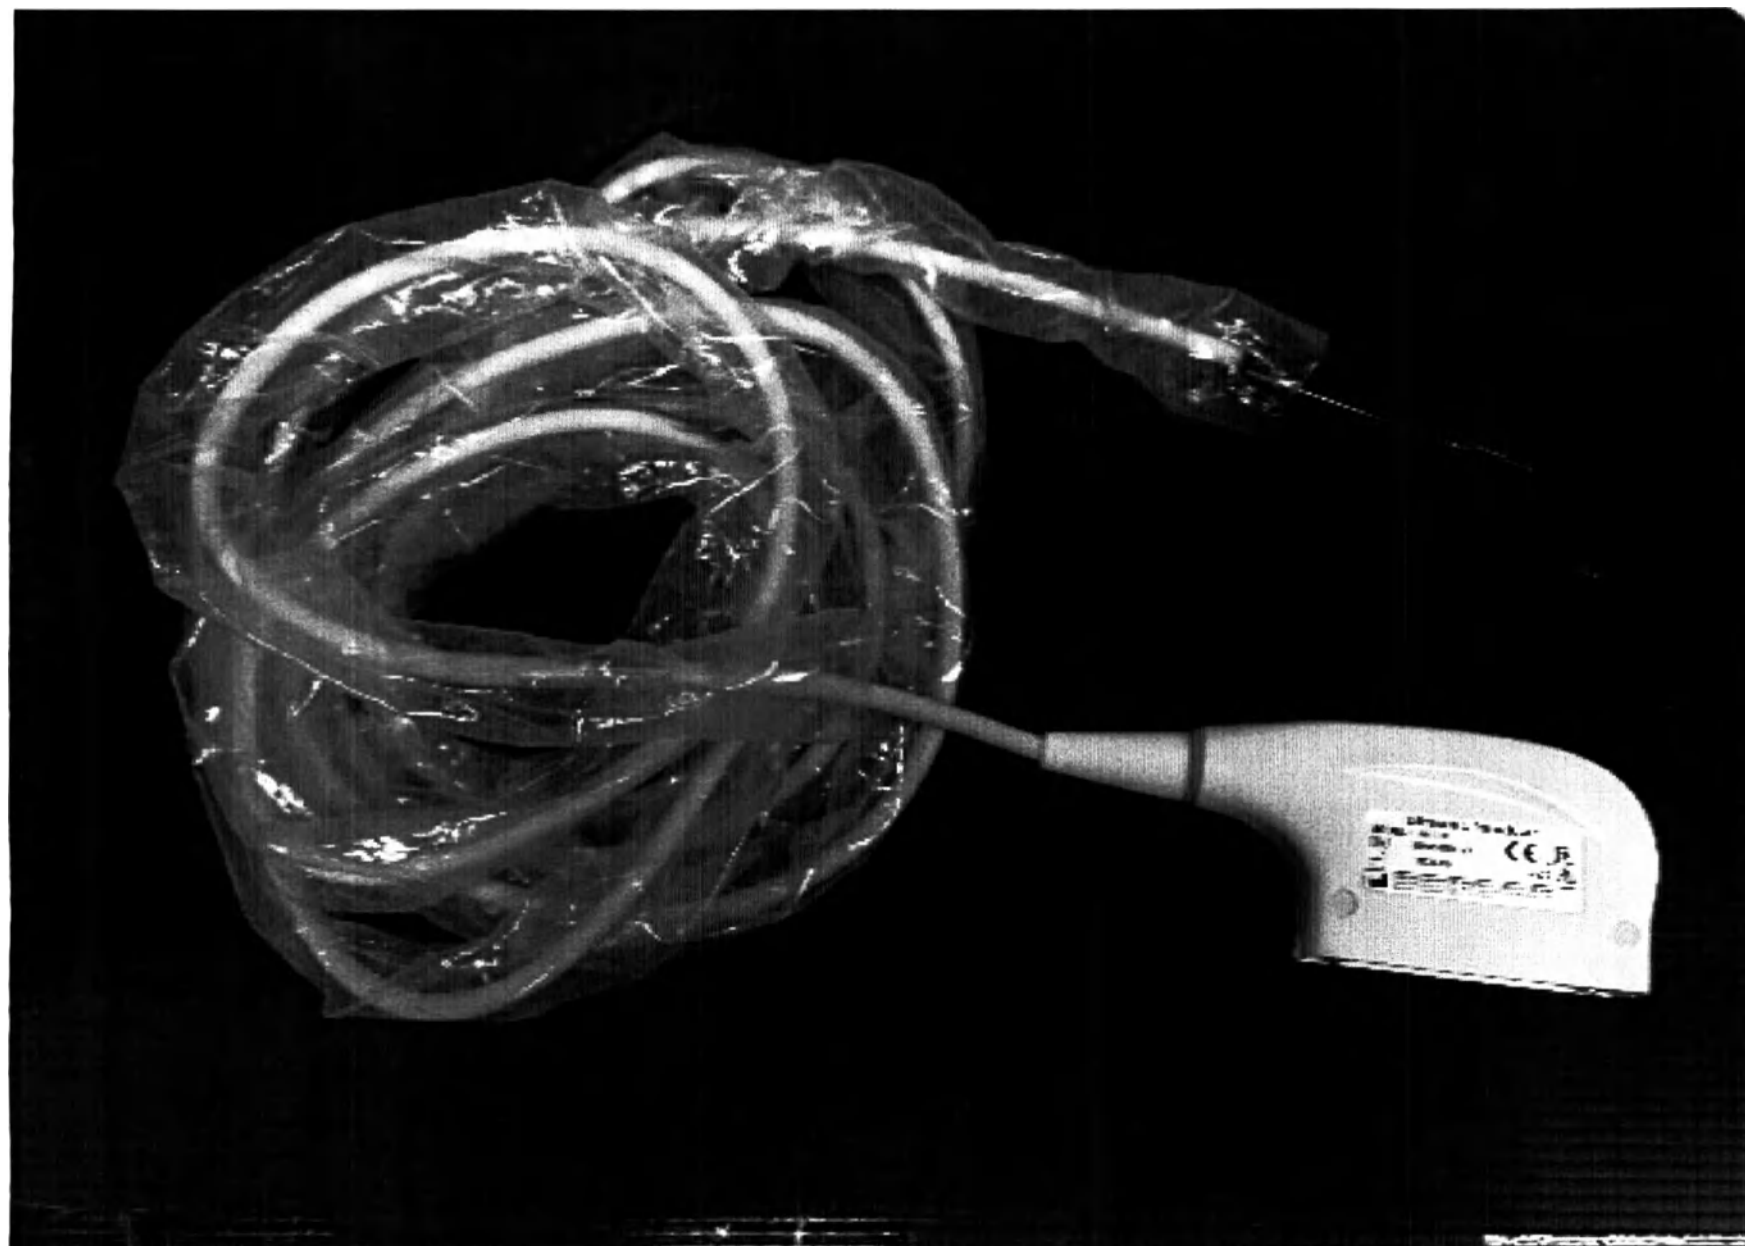


24.17. Датчик ультразвуковой линейный L7-3s



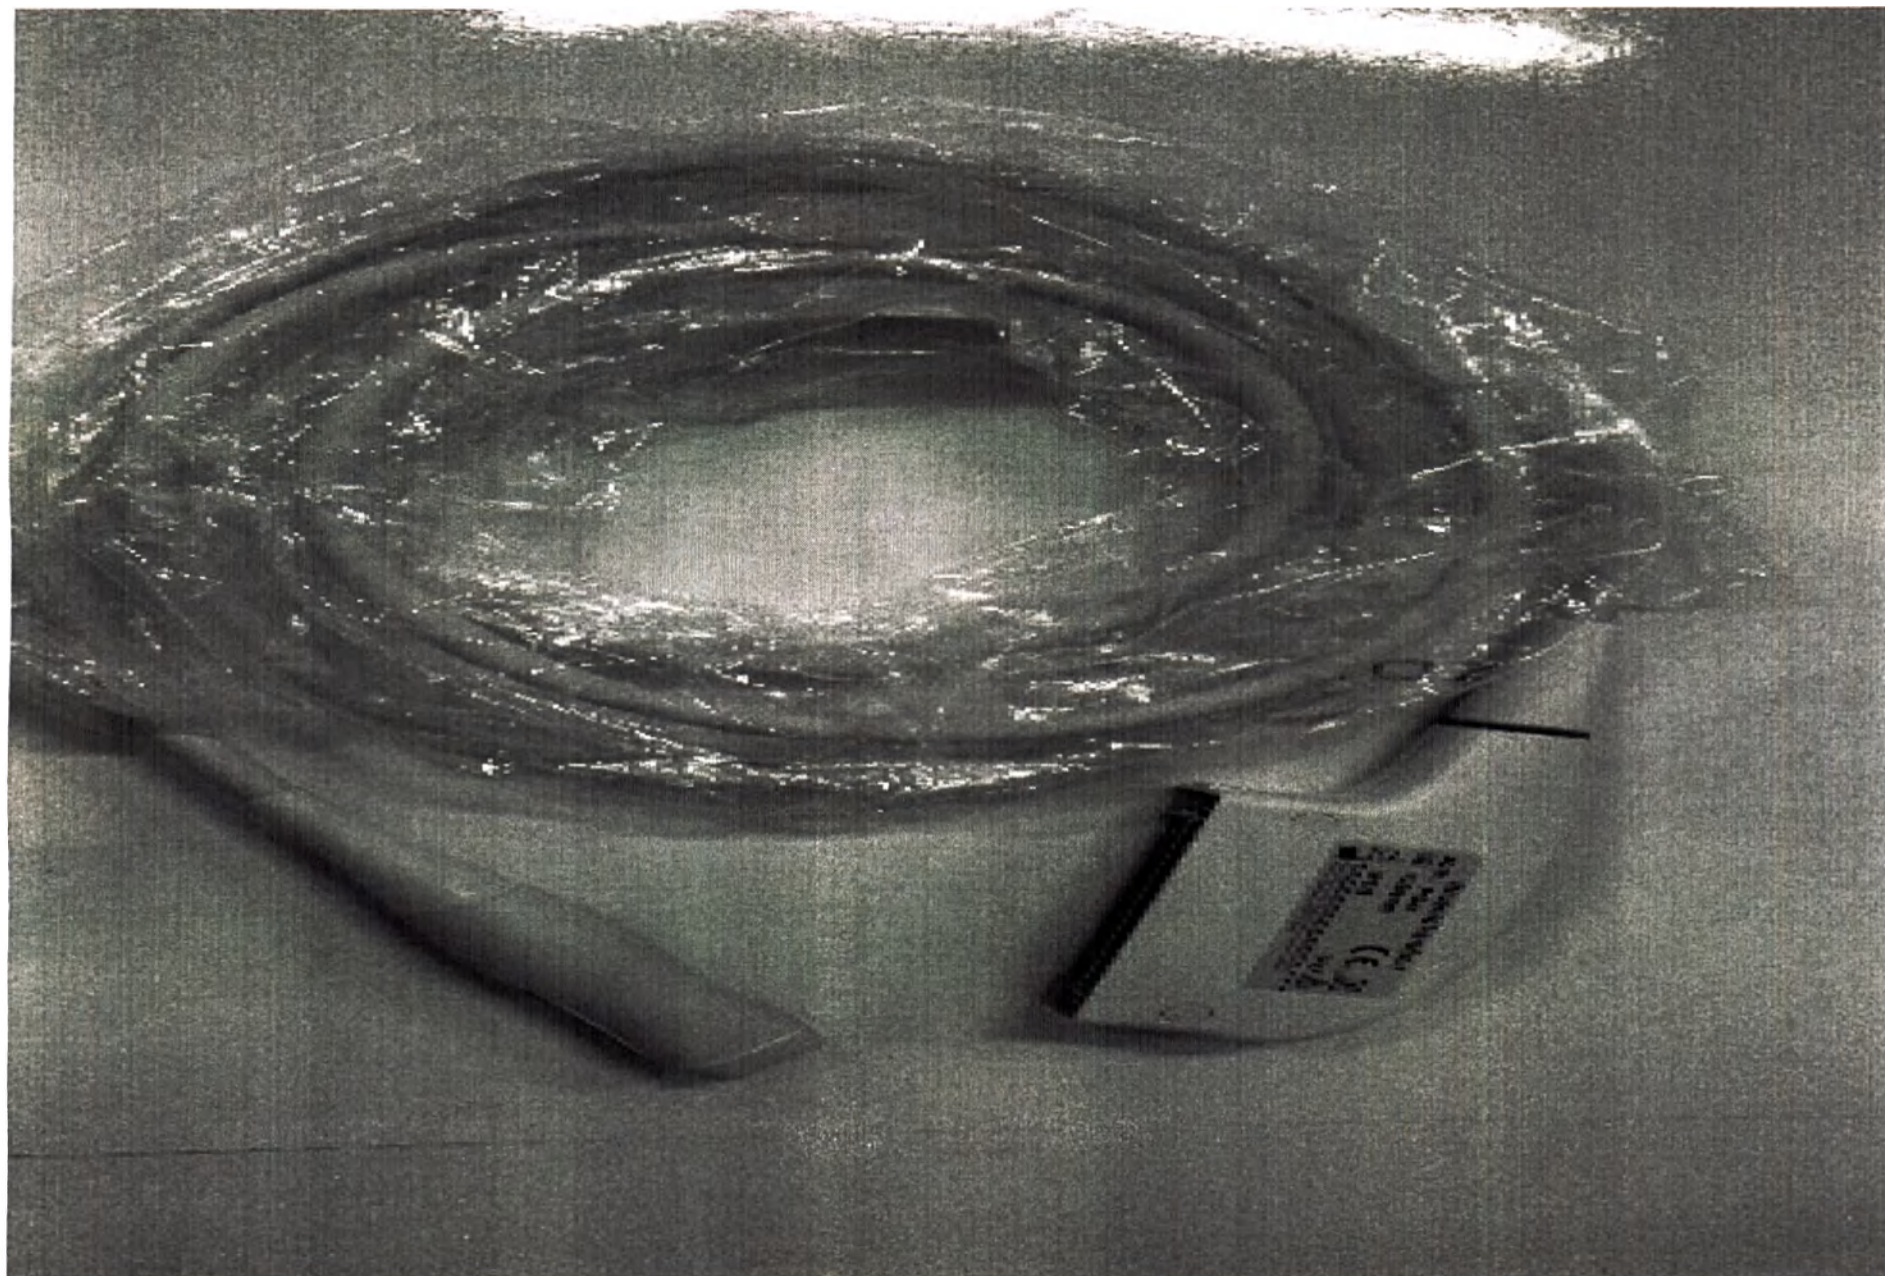




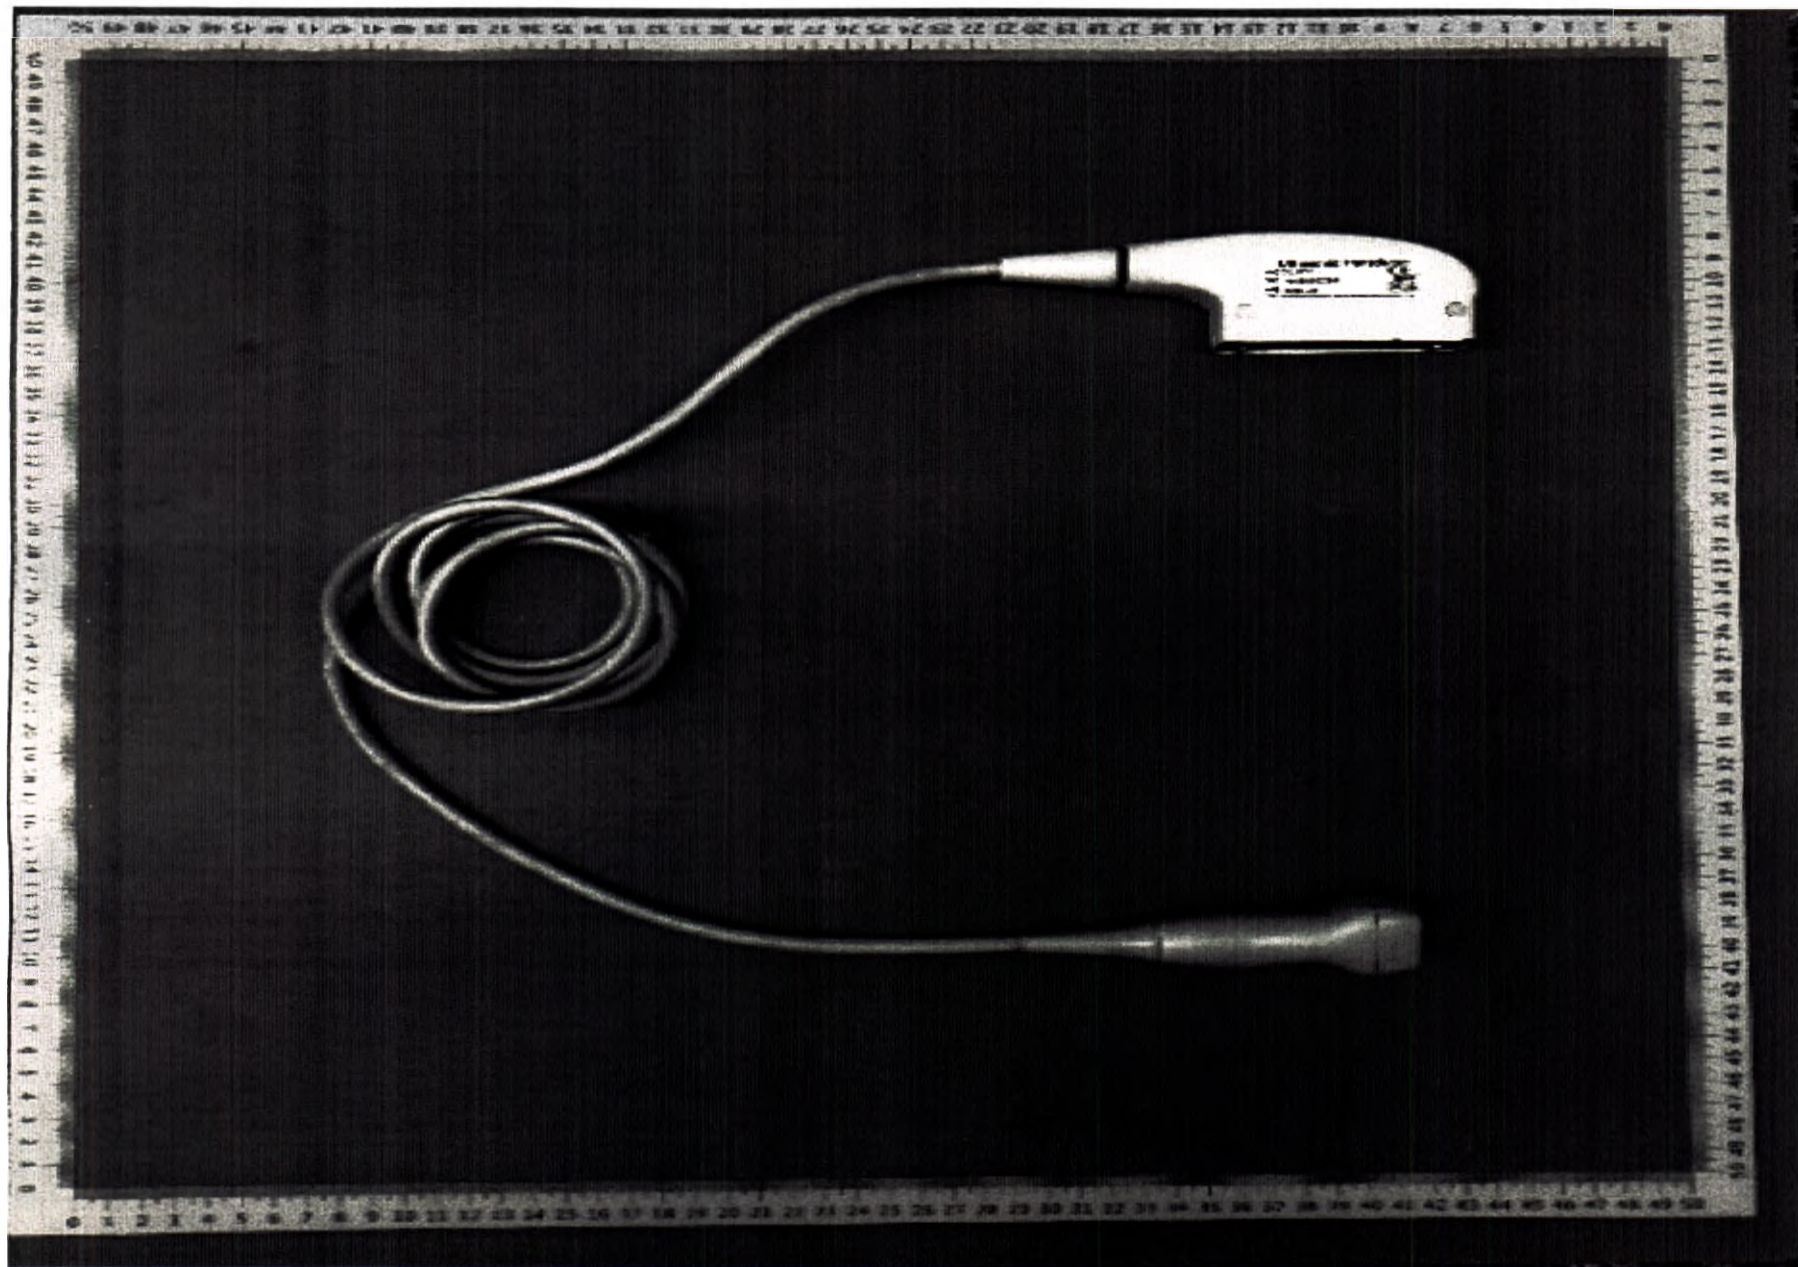


24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный Р7-3Ts в составе:


24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

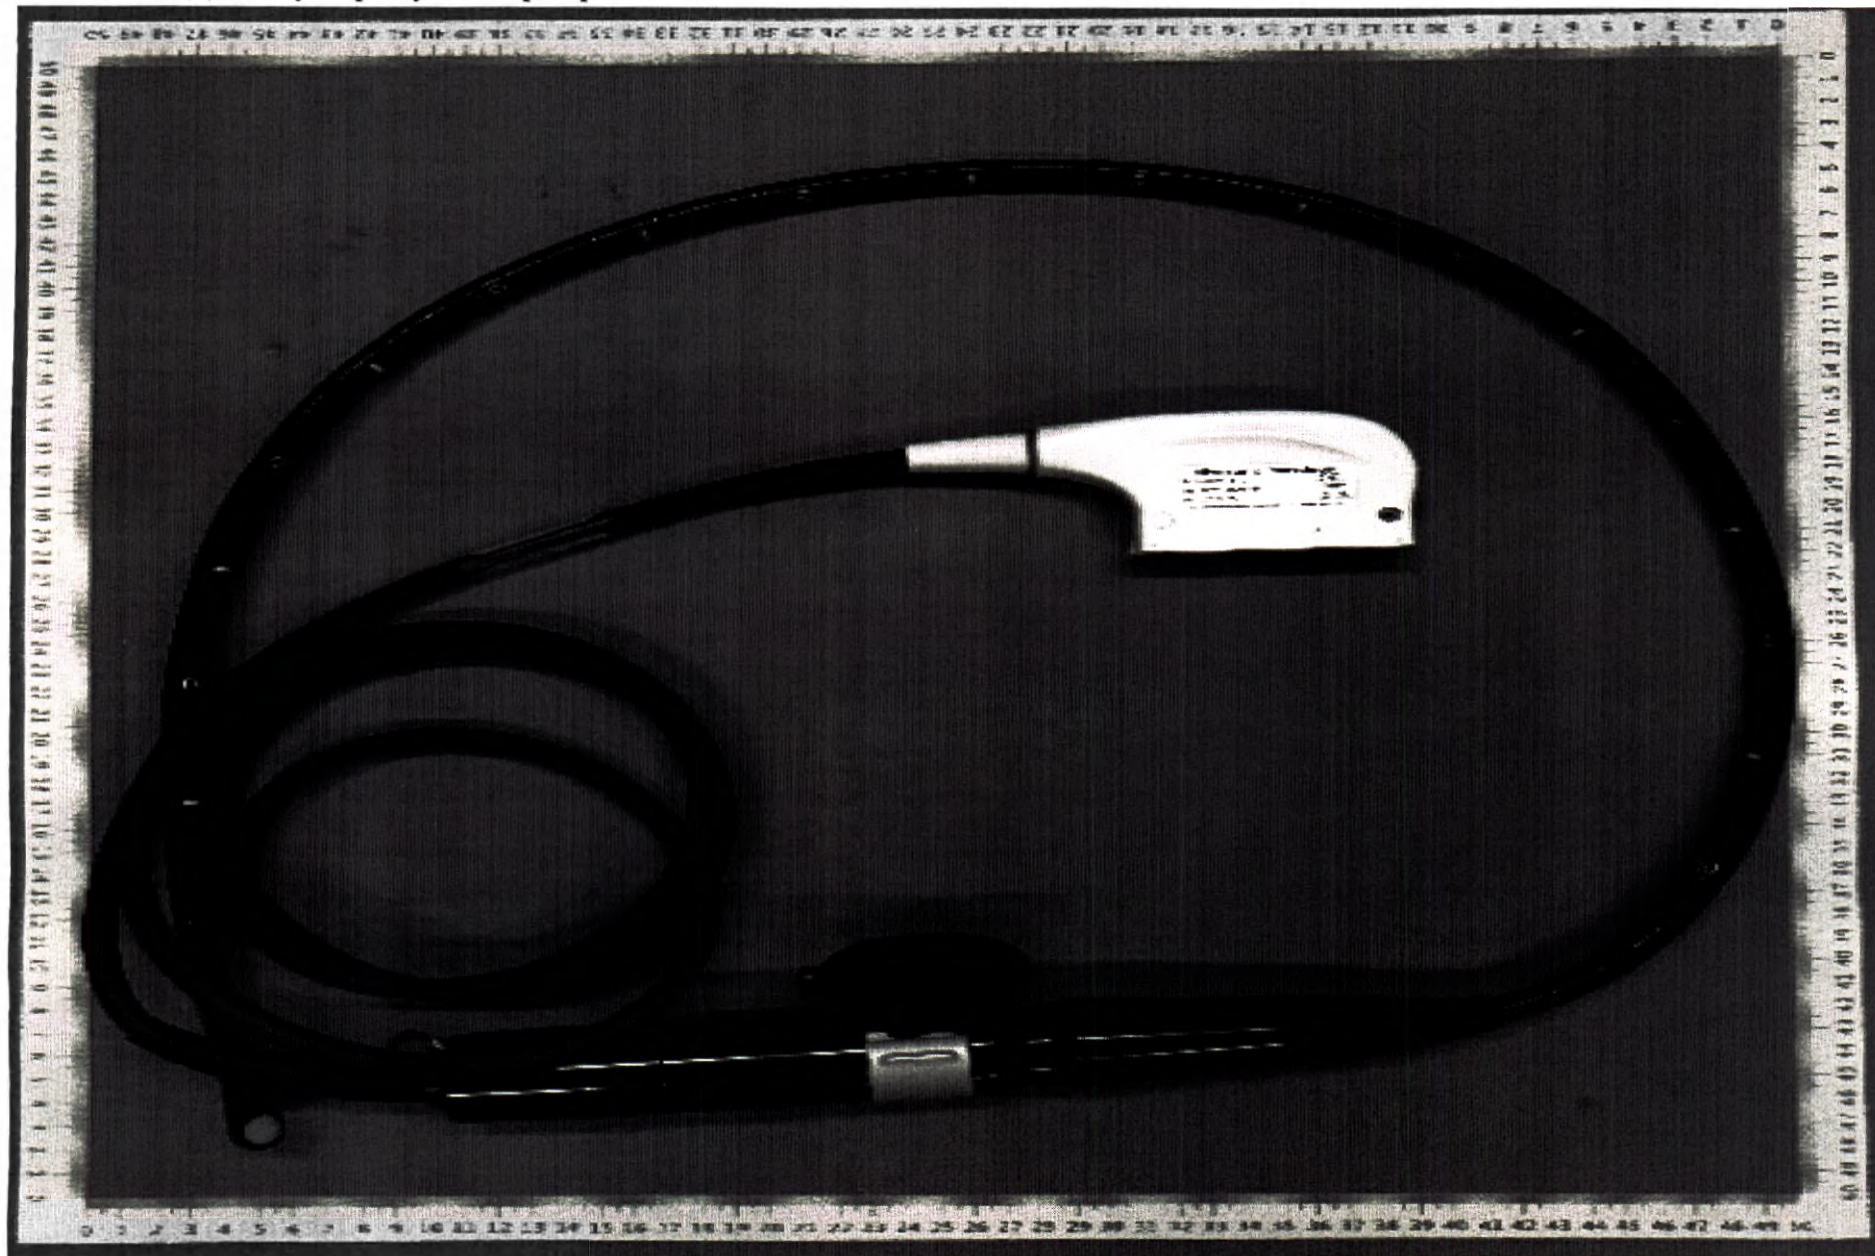



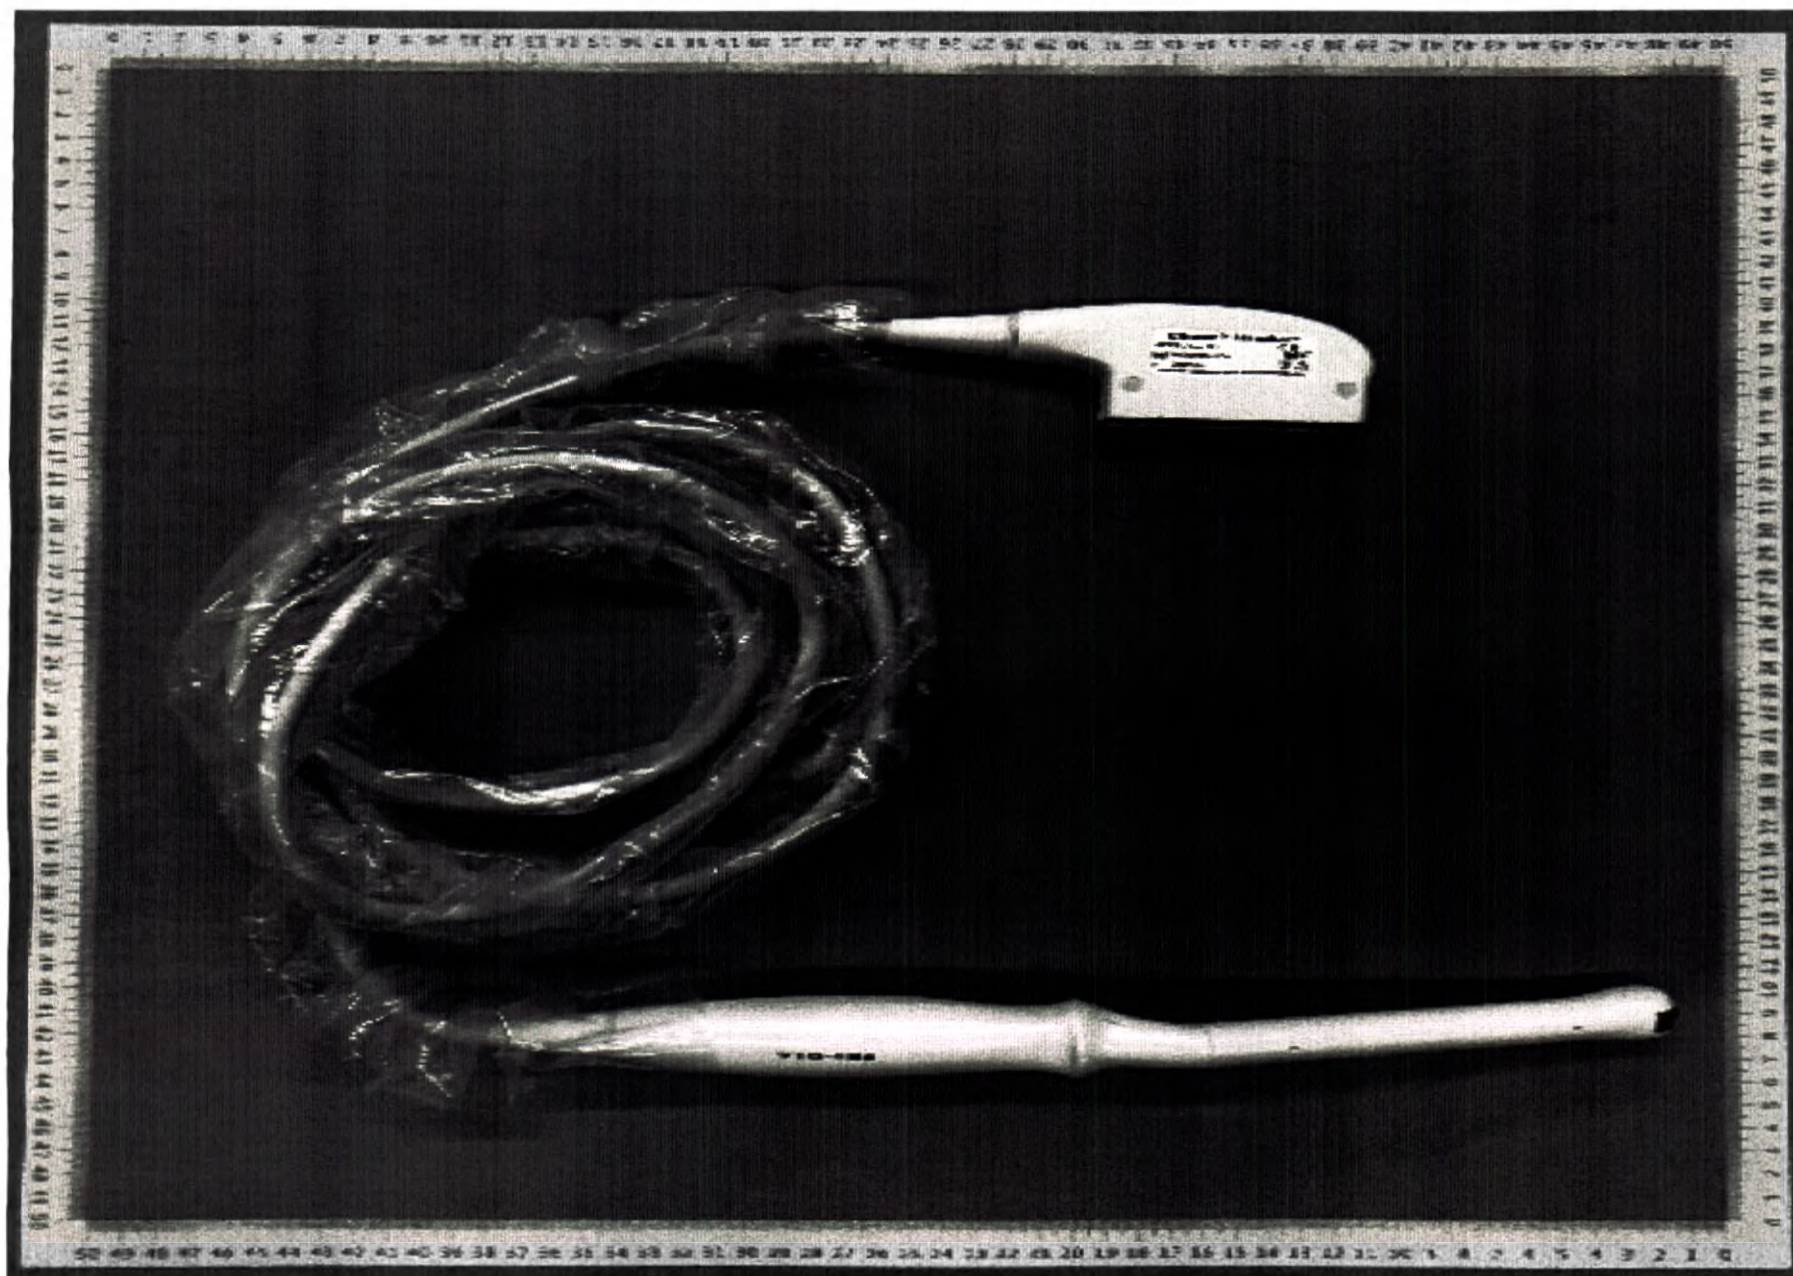

24.23. Датчик ультразвуковой конвексный внутриволостной V10-4s

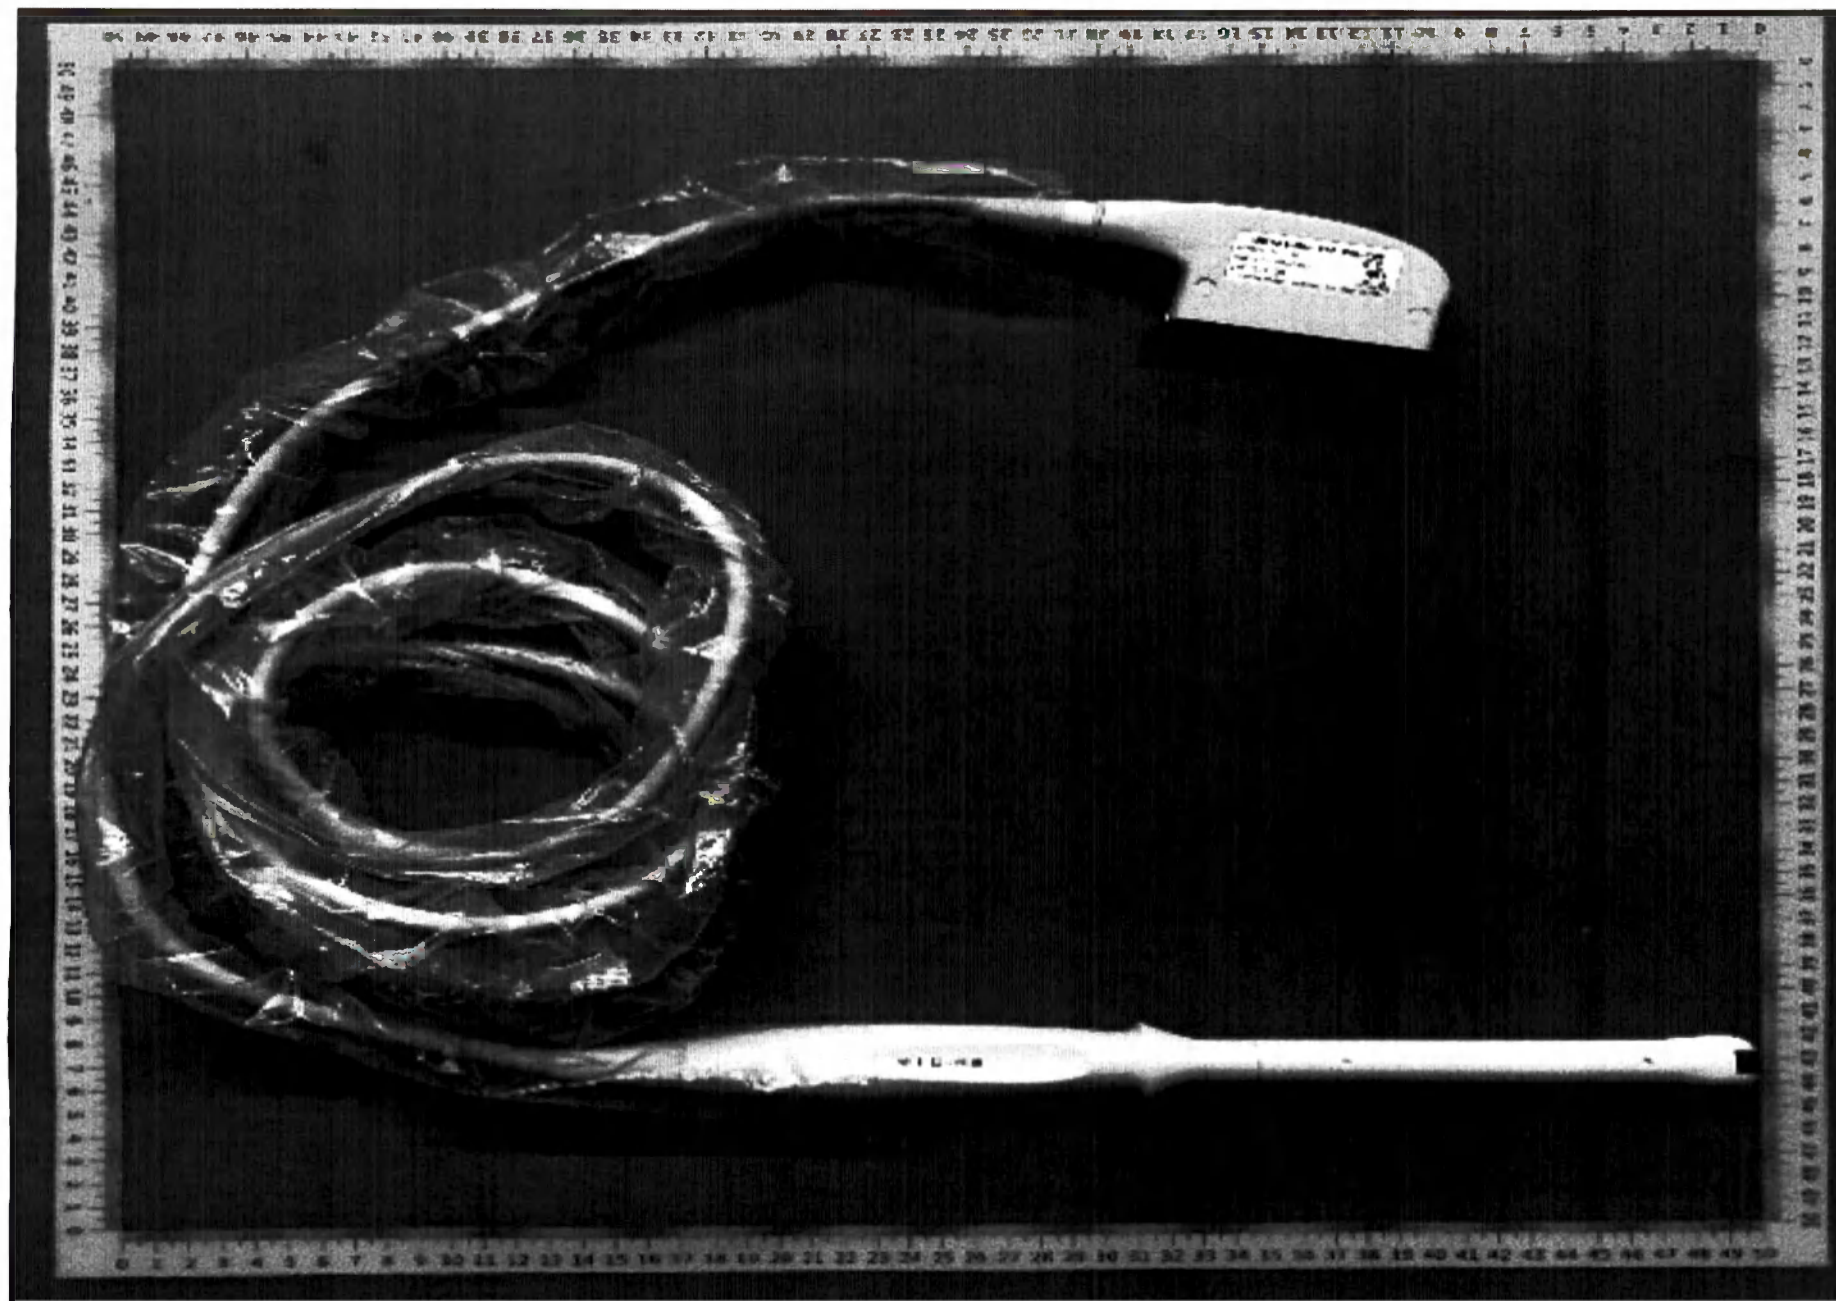

25. Насадки биопсийные, варианты исполнения


25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004










25.4. Насадка биопсийная пластиковая, со съемной направляющей для игл NGB-006

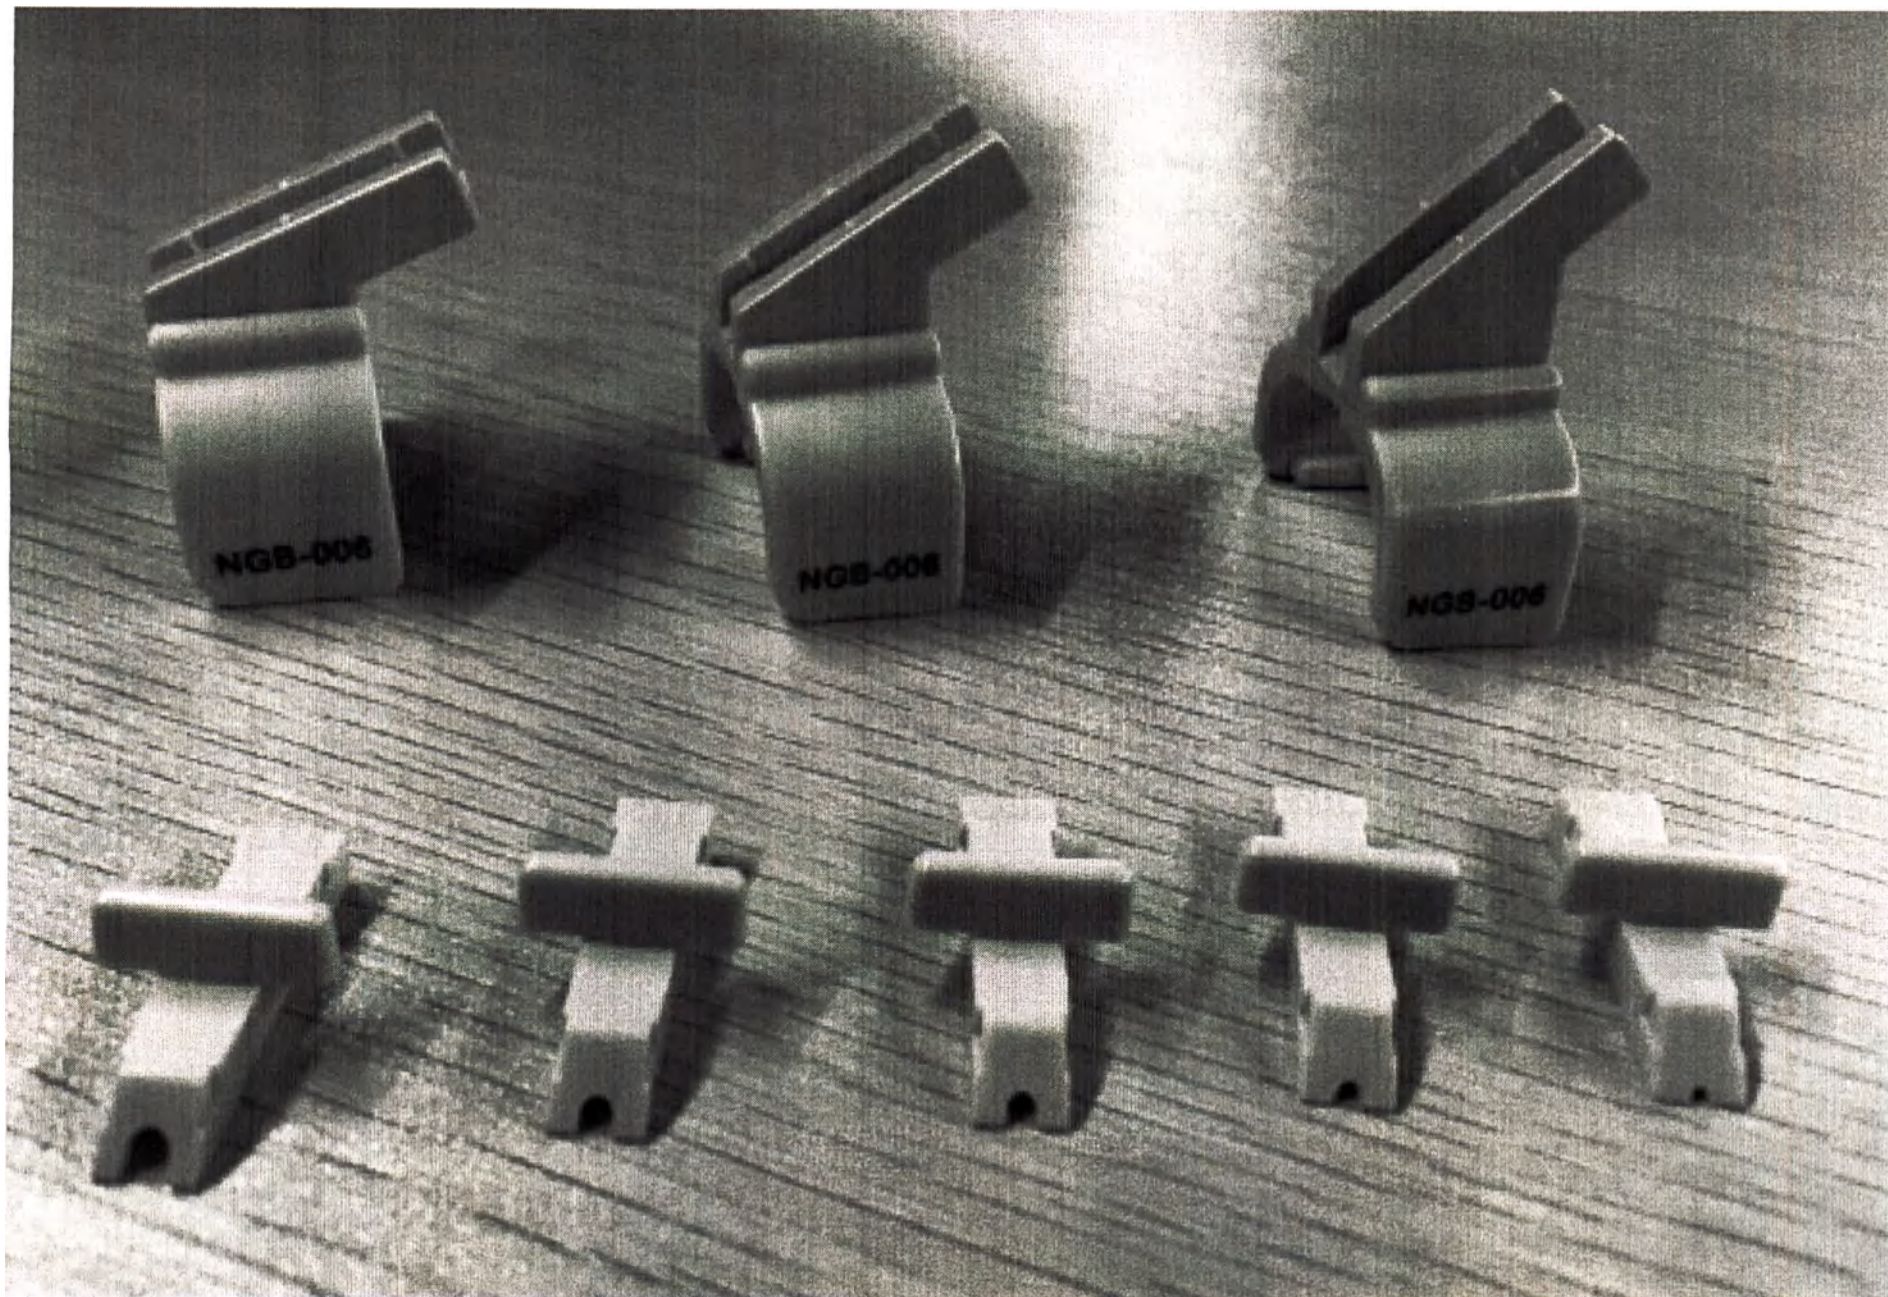




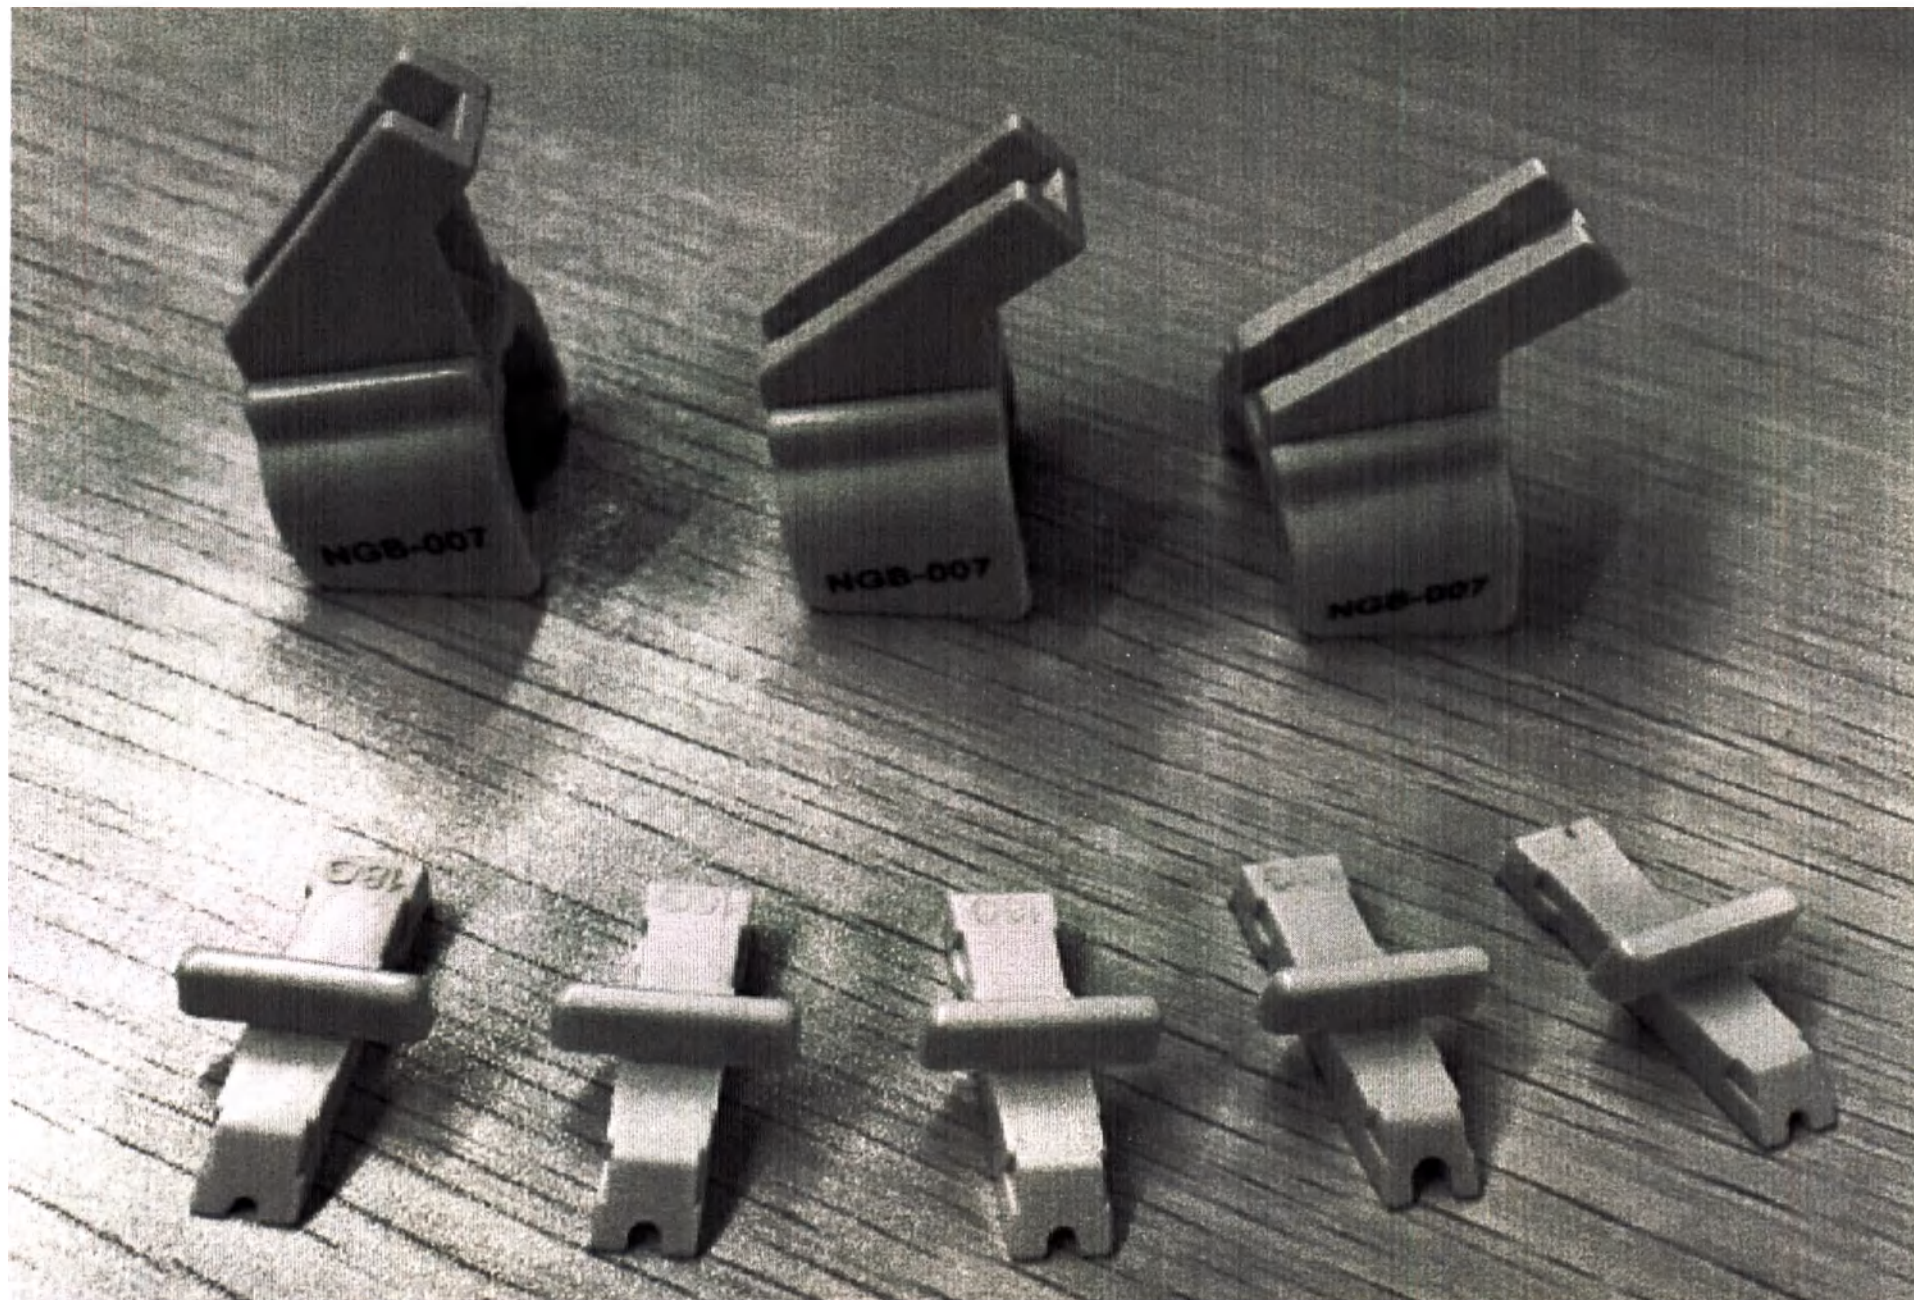

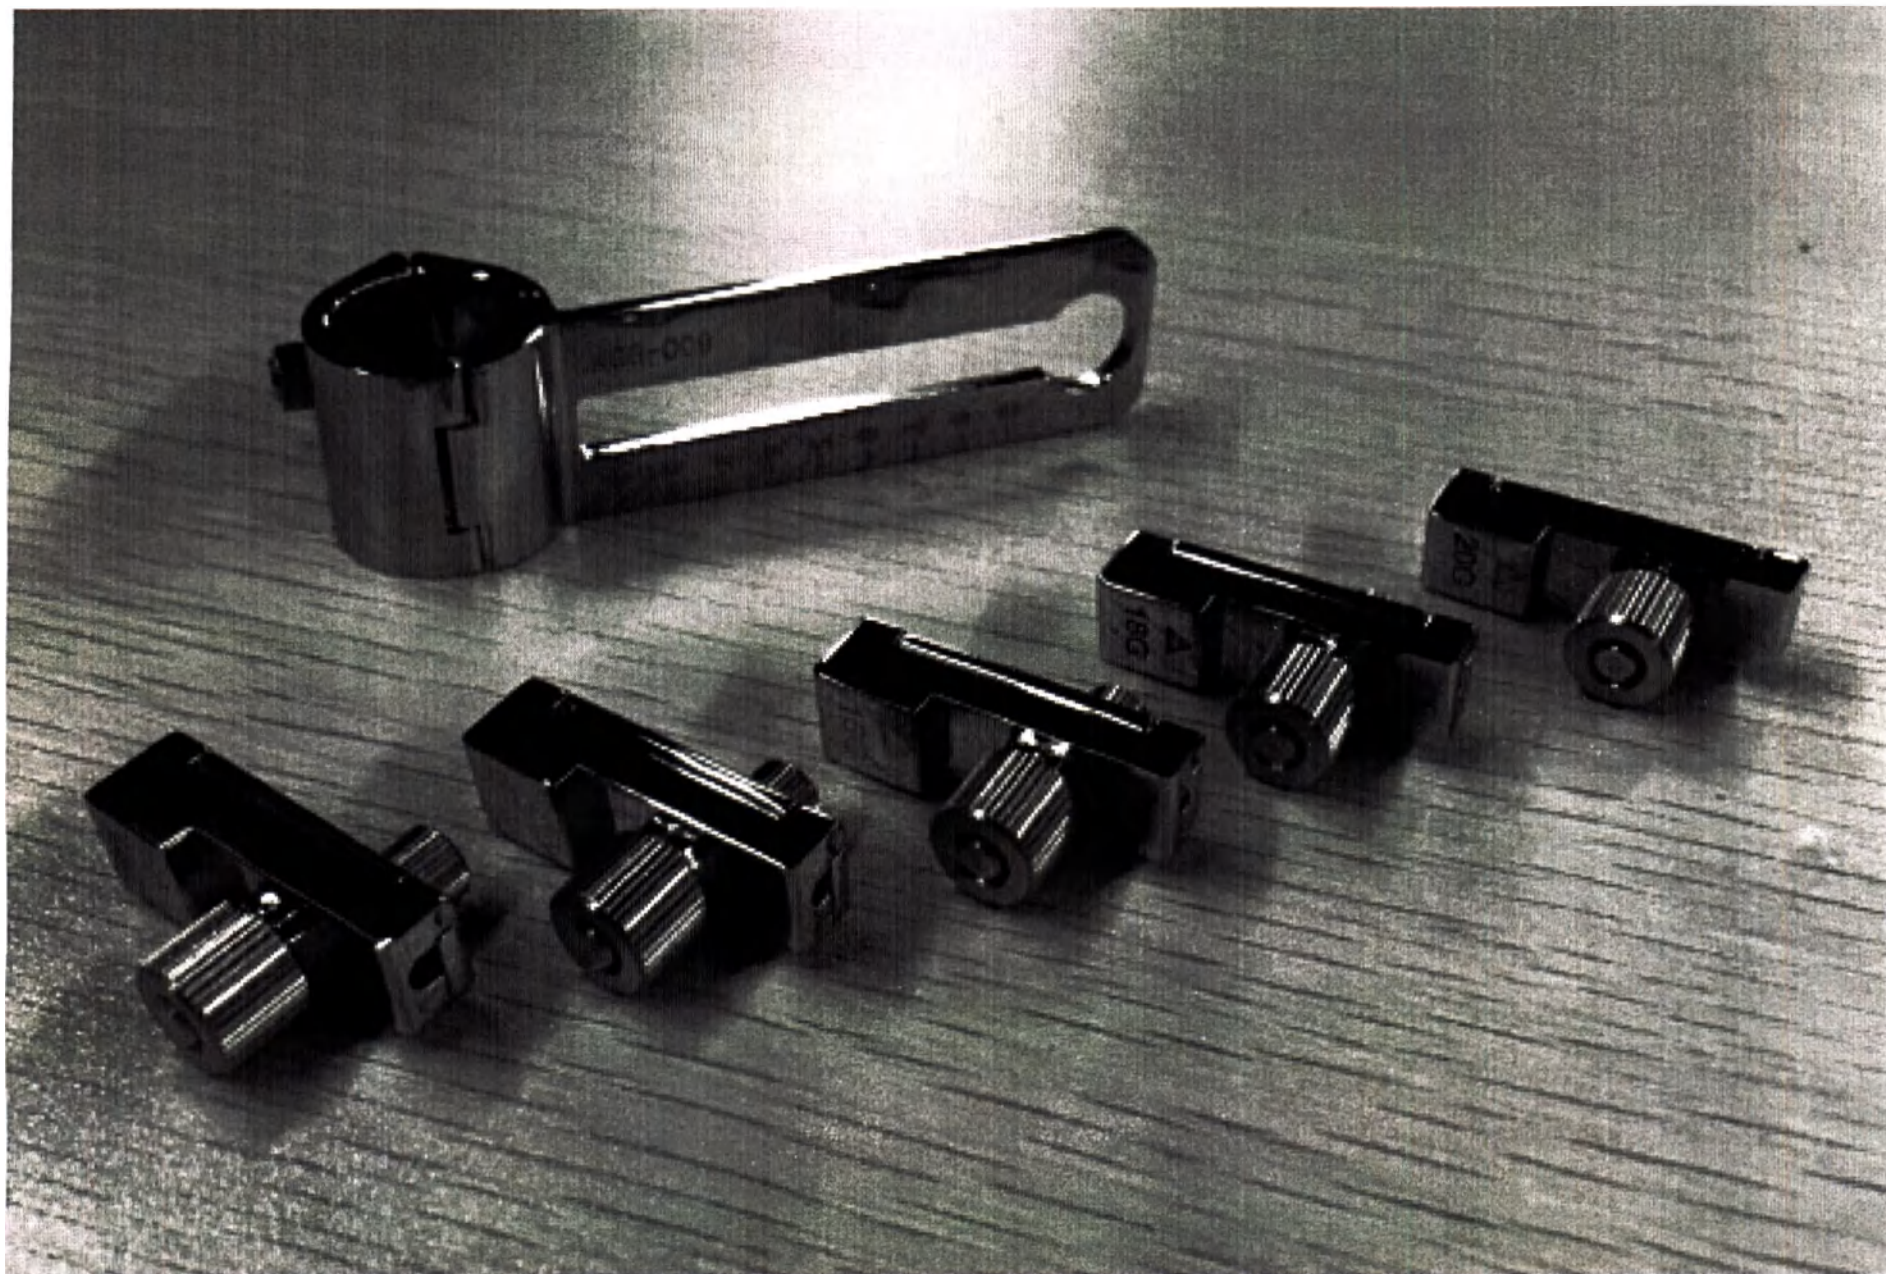

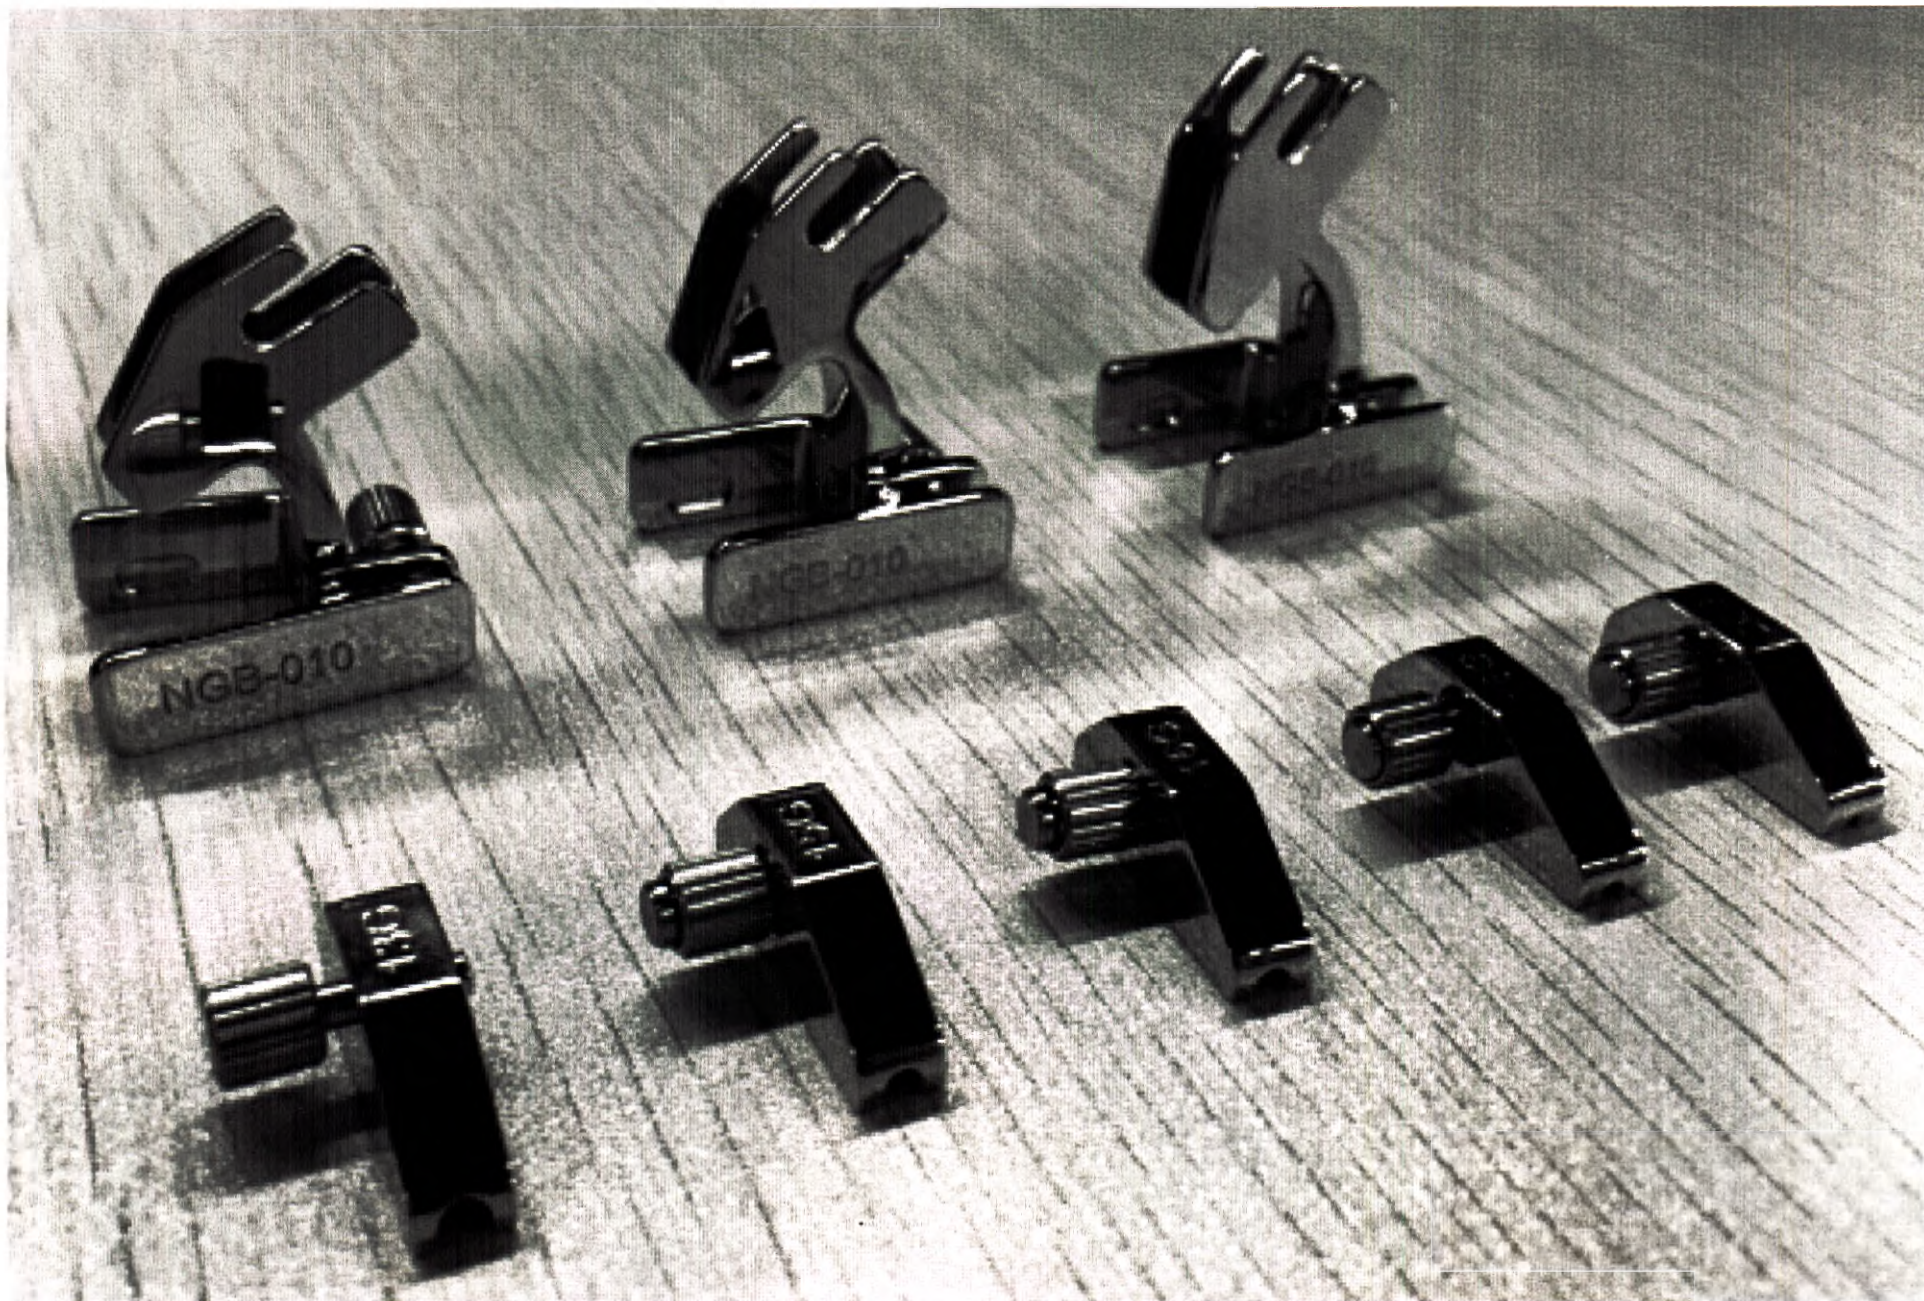

25.9.Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-015

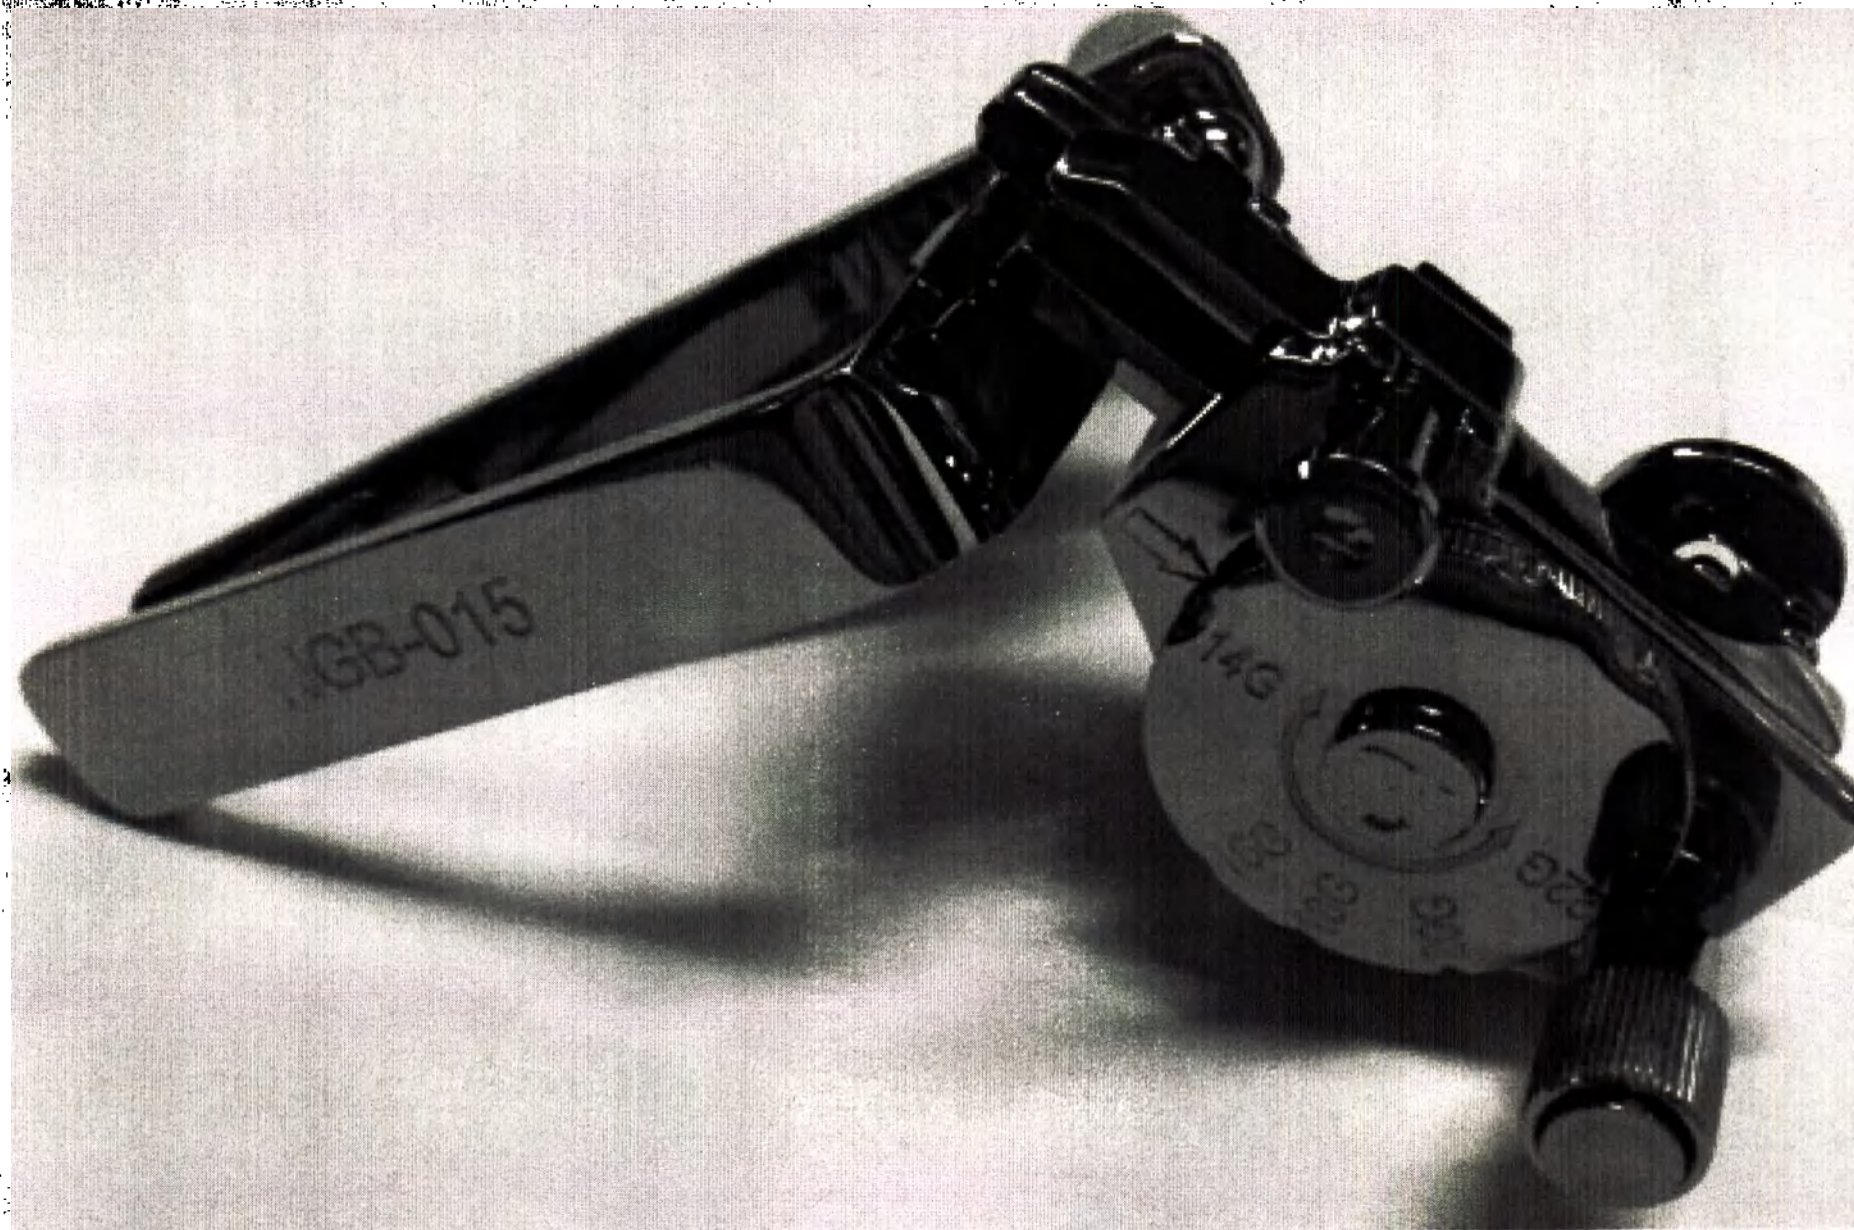




25.11. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018



26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)



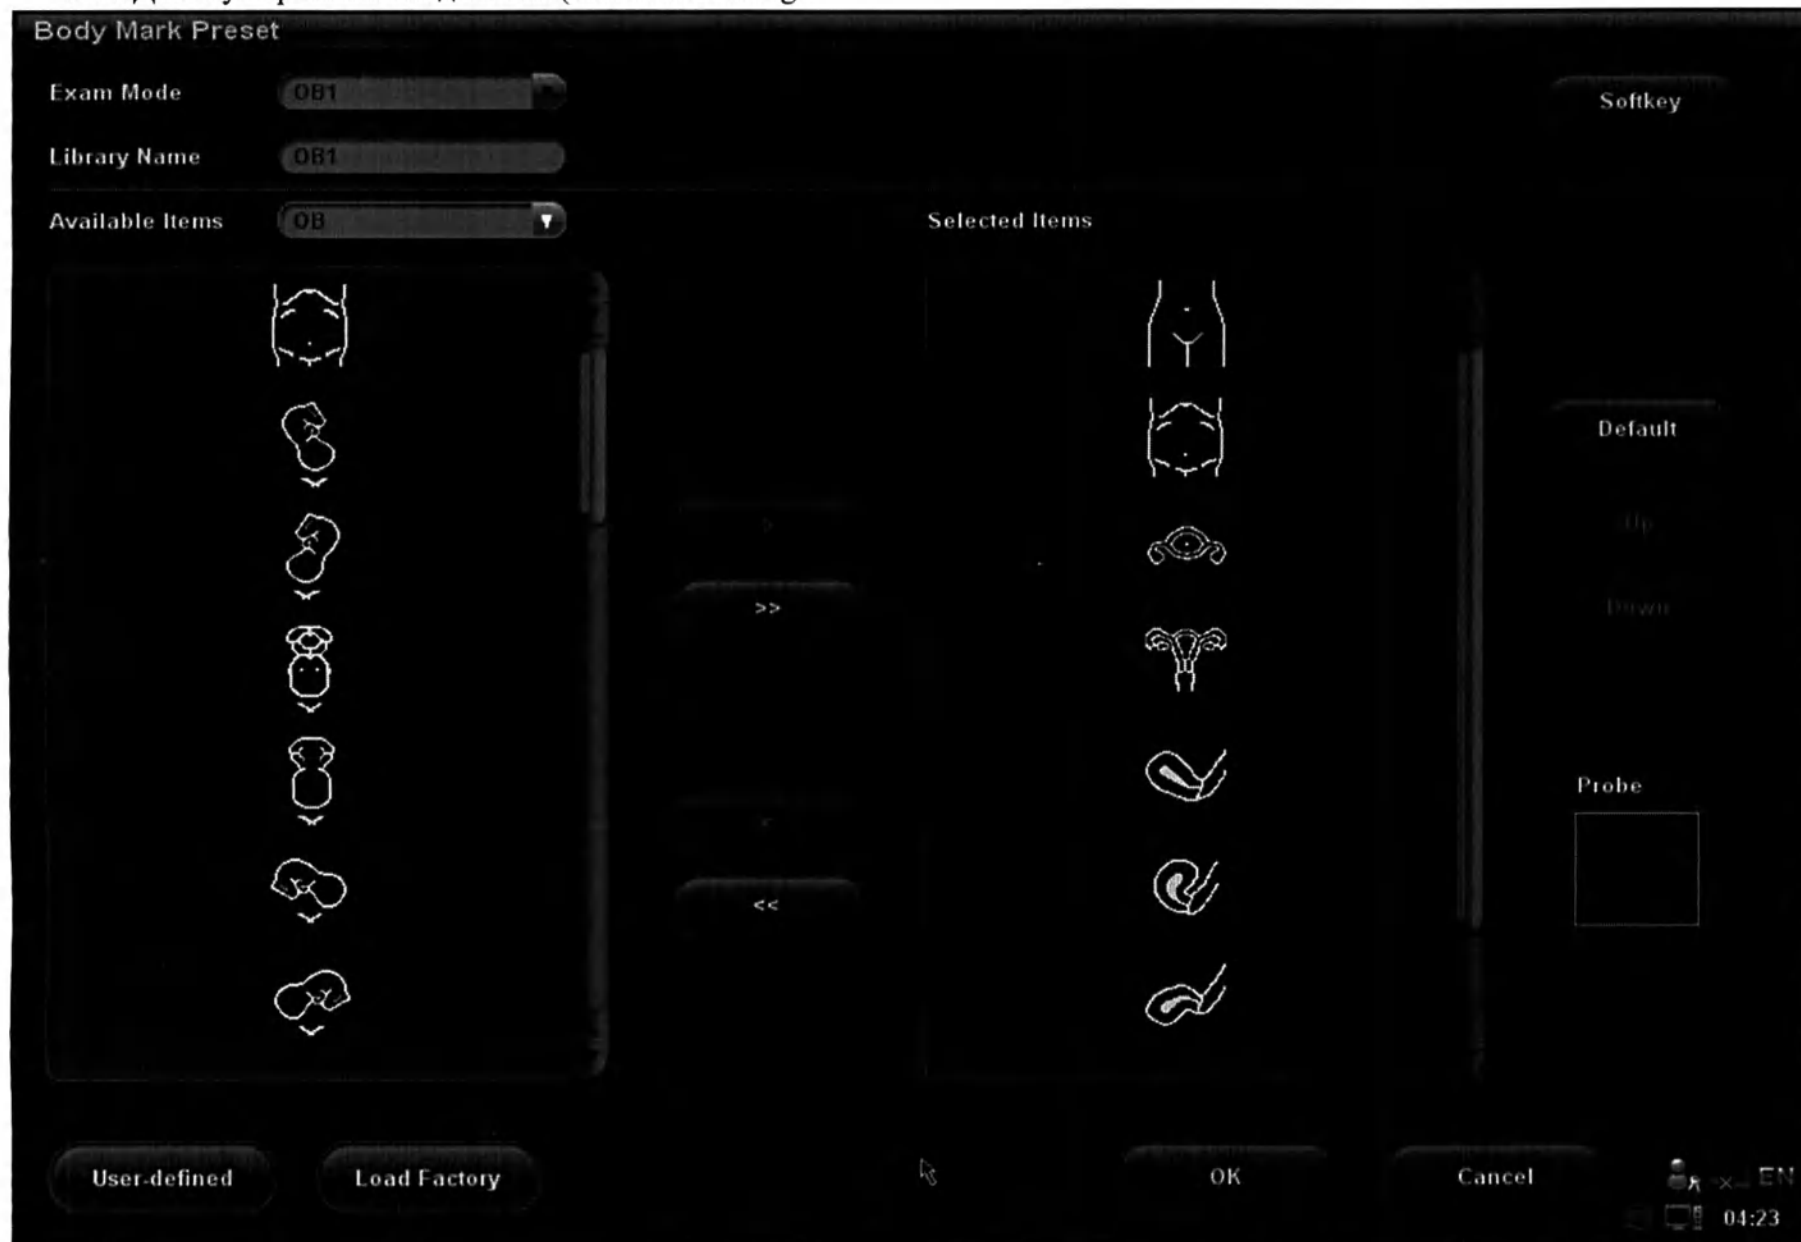

26.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package)

Body Mark Preset

Exam Mode: Softkey

Library Name:

Available Items	Selected Items
	
	
	
	
	
	
	

Default

Probe

User defined Load Factory OK Cancel

01/20

26.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package)



26.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package)



26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

Body Mark Preset

Exam Mode: ▼

Library Name:

Available Items:

Selected Items:



>>



Softkey


Default

Probe

User defined Load Factory OK Cancel

01:20

26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)

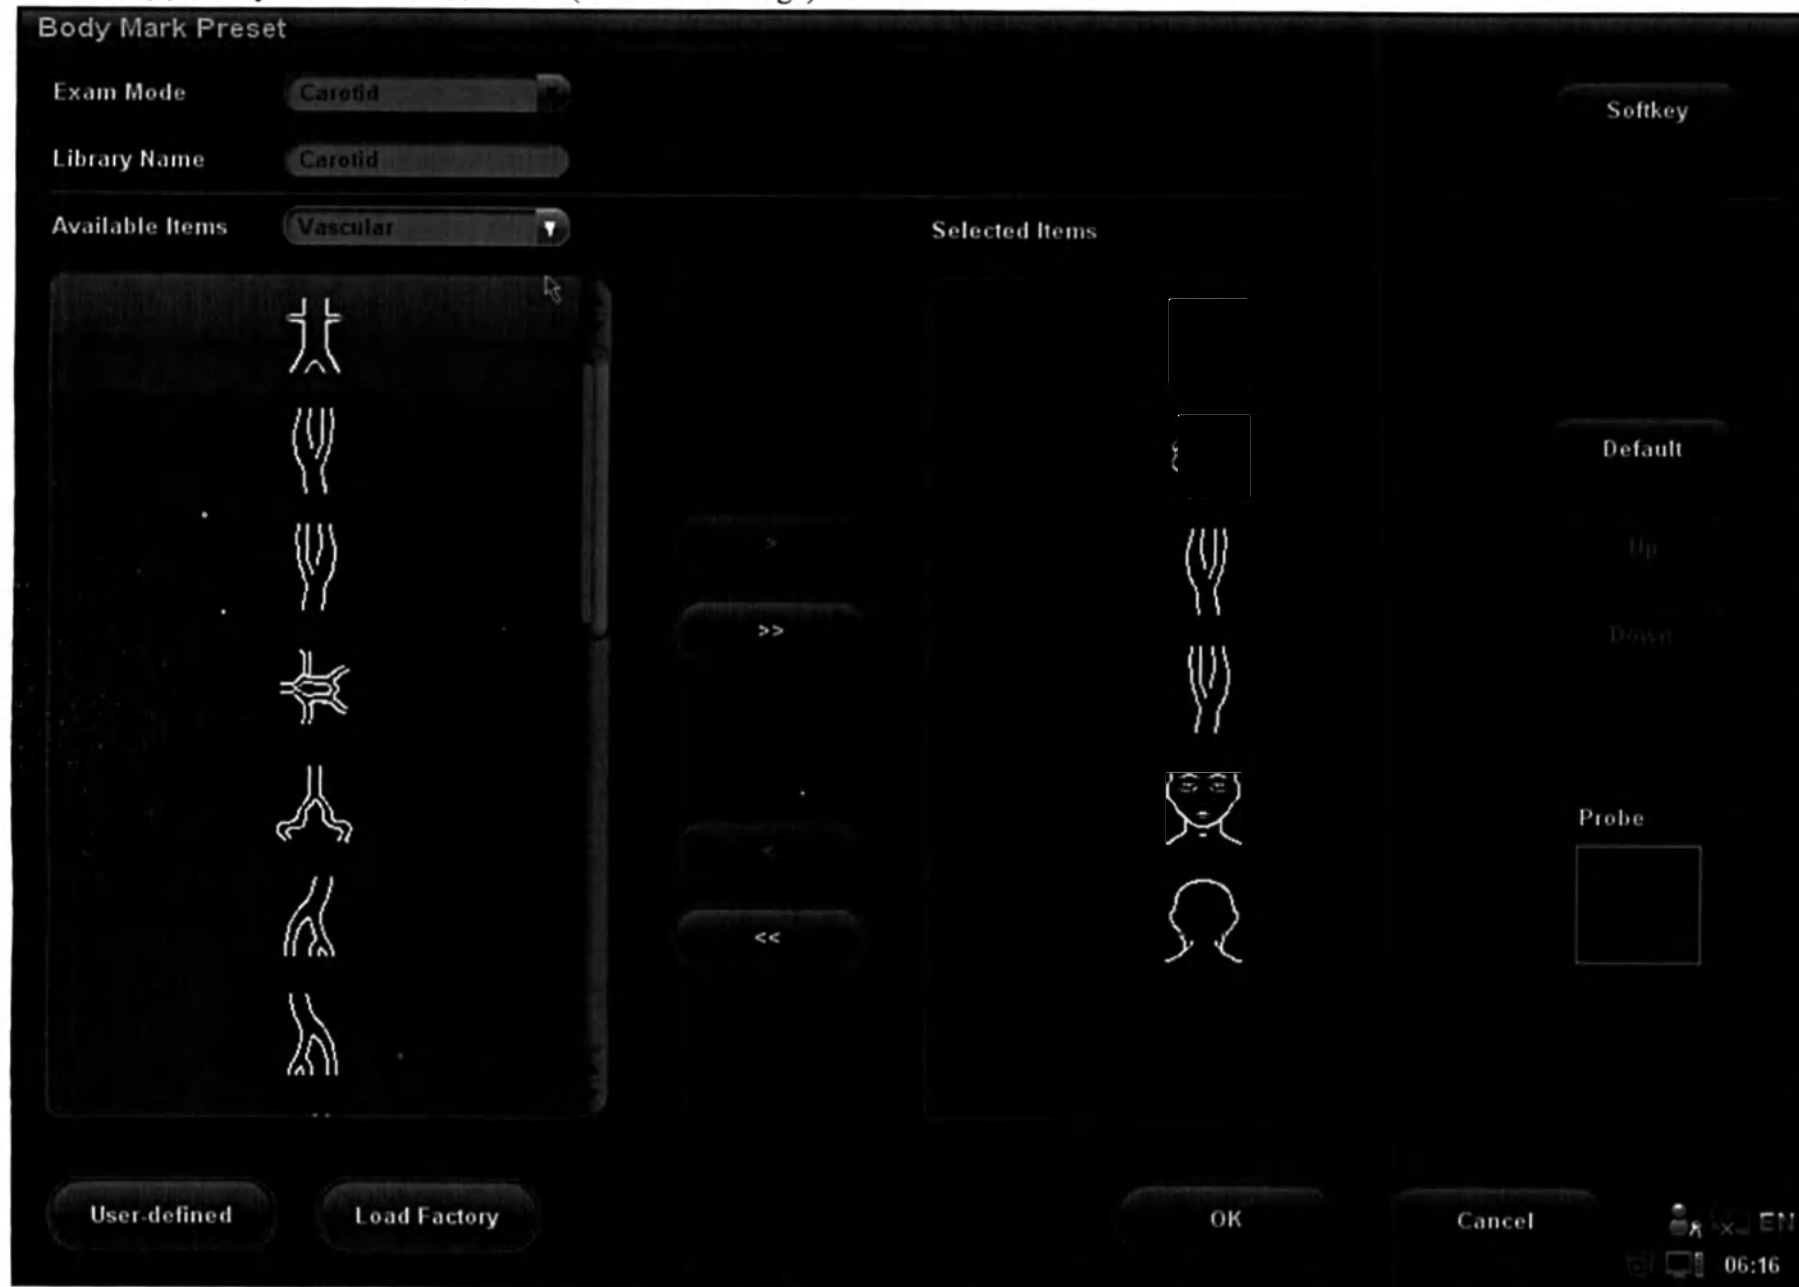

26.8. Для исследований в педиатрии (Pediatrics Package)

Body Mark Preset

Exam Mode Softkey


Library Name

Available Items	Selected Items

User defined Load Factory OK Cancel

01:25


26.9. Для исследований нервов (Nerve Package)

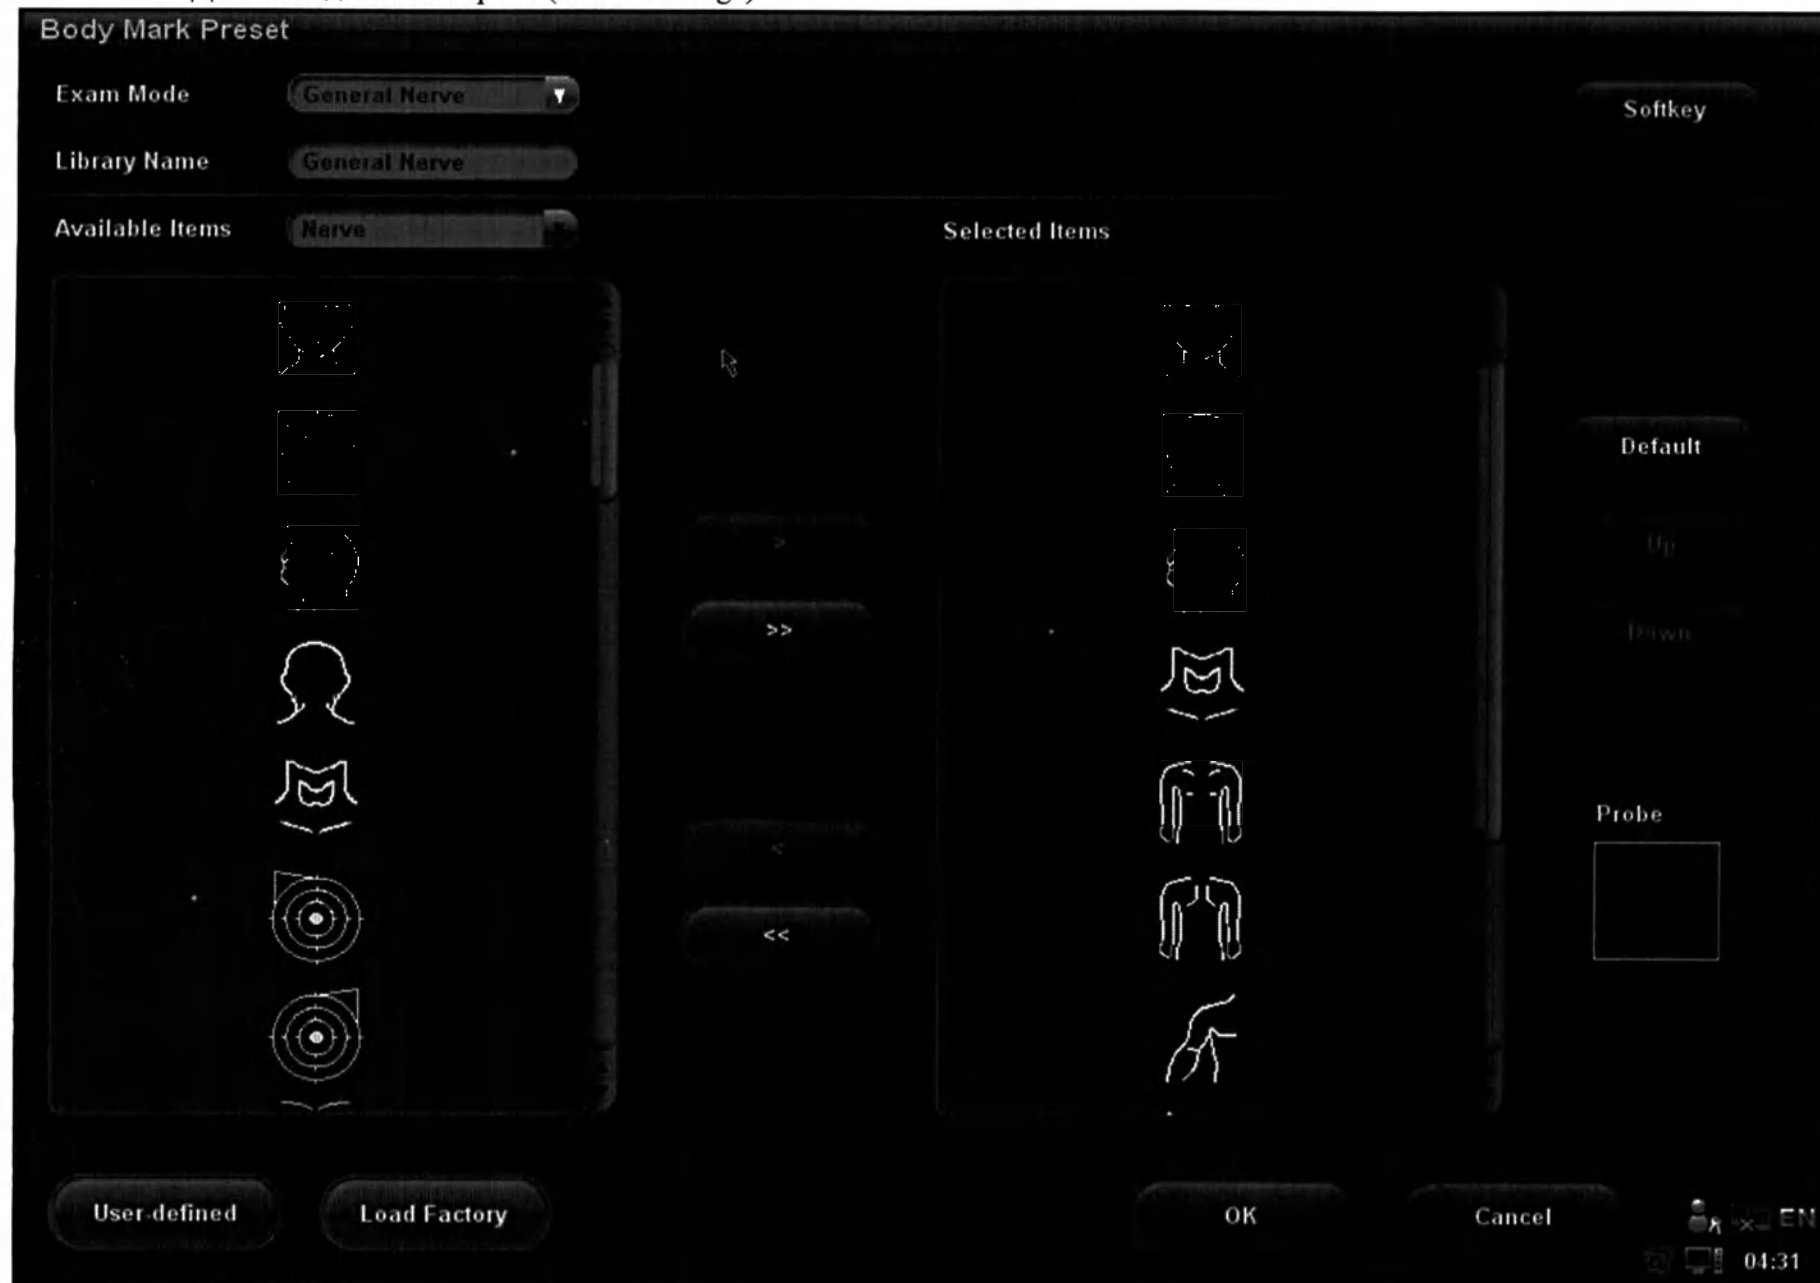




26.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)



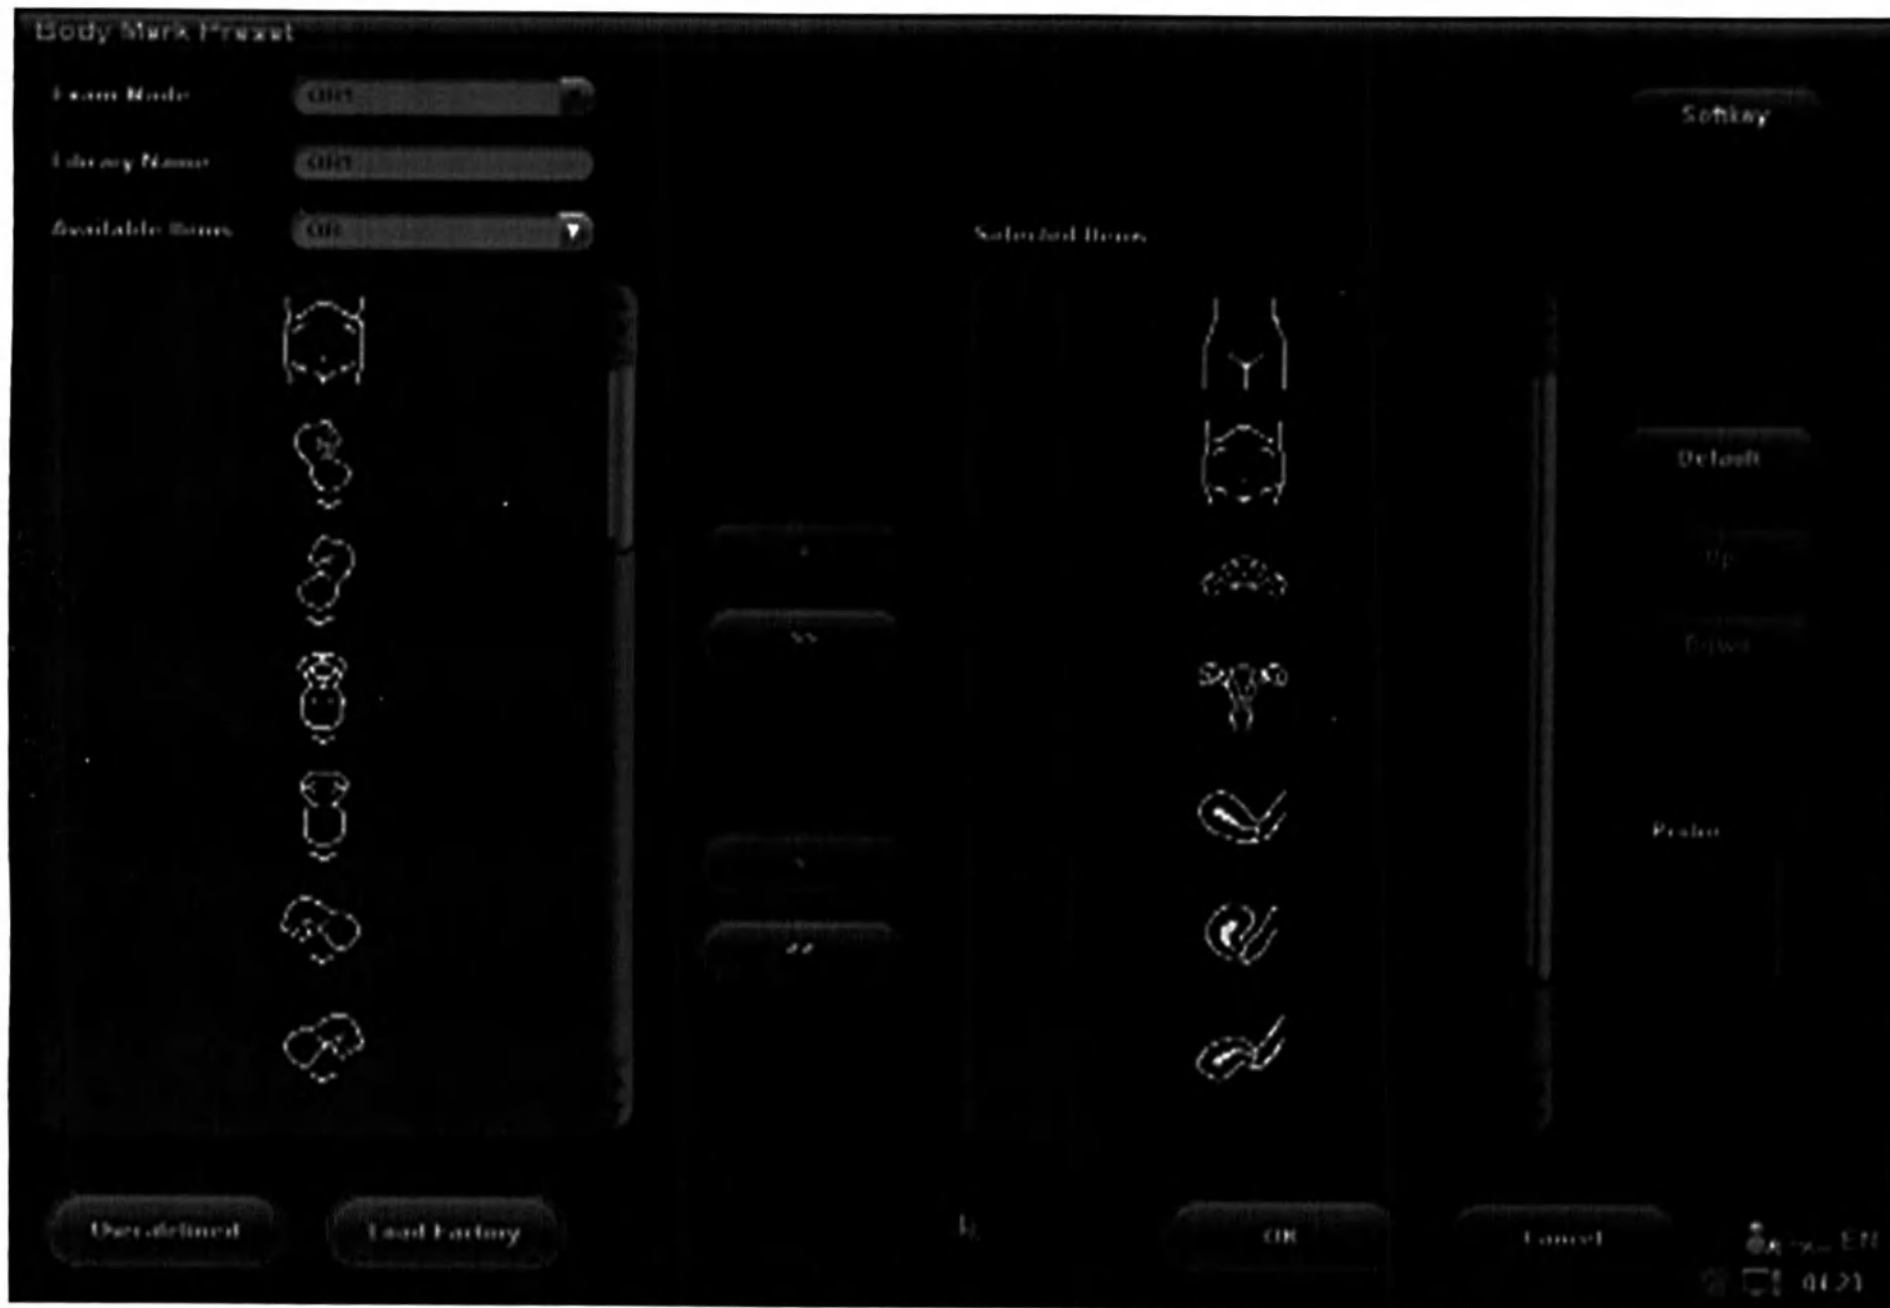








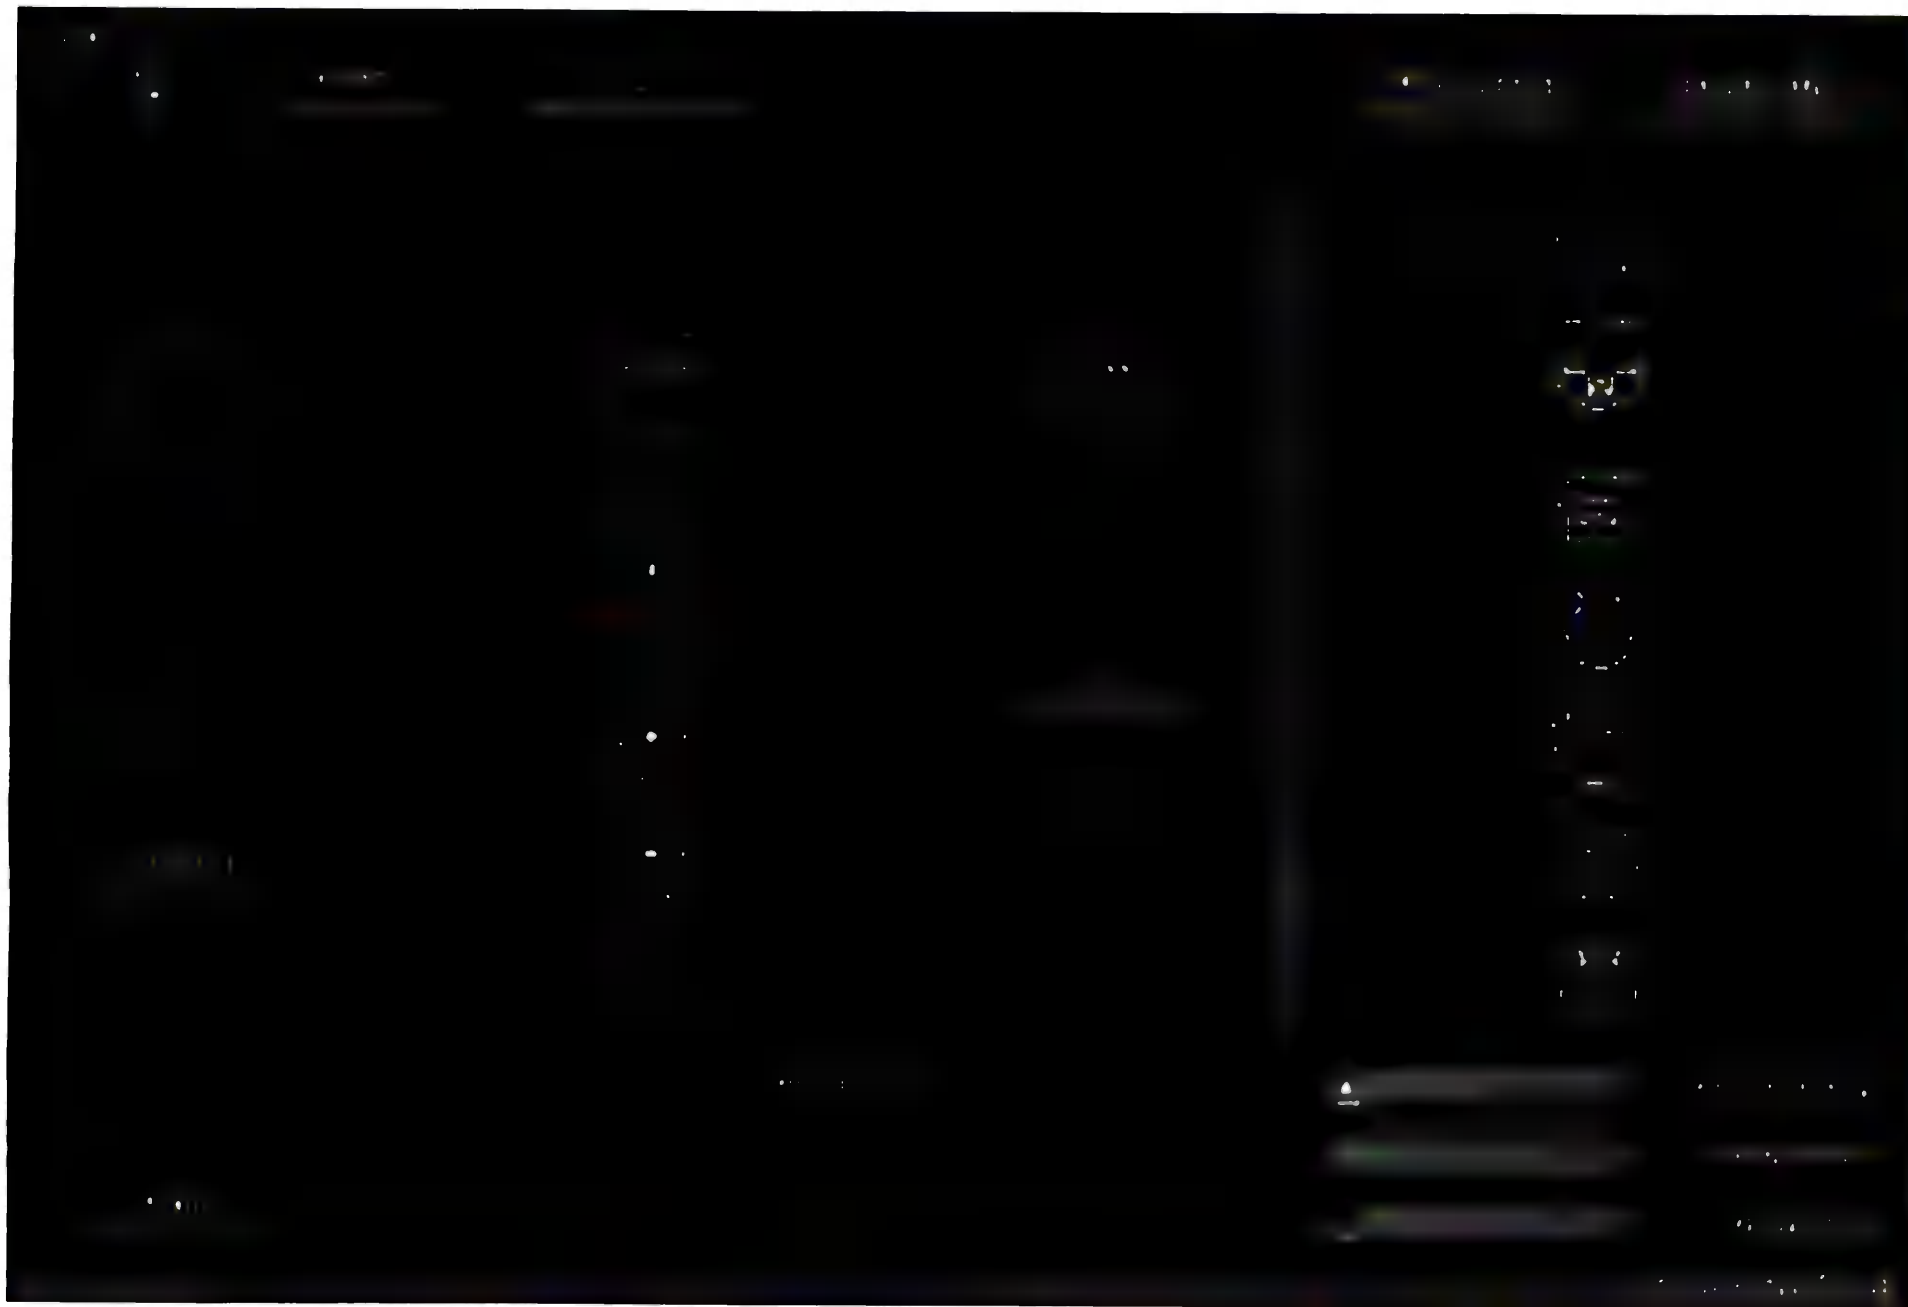



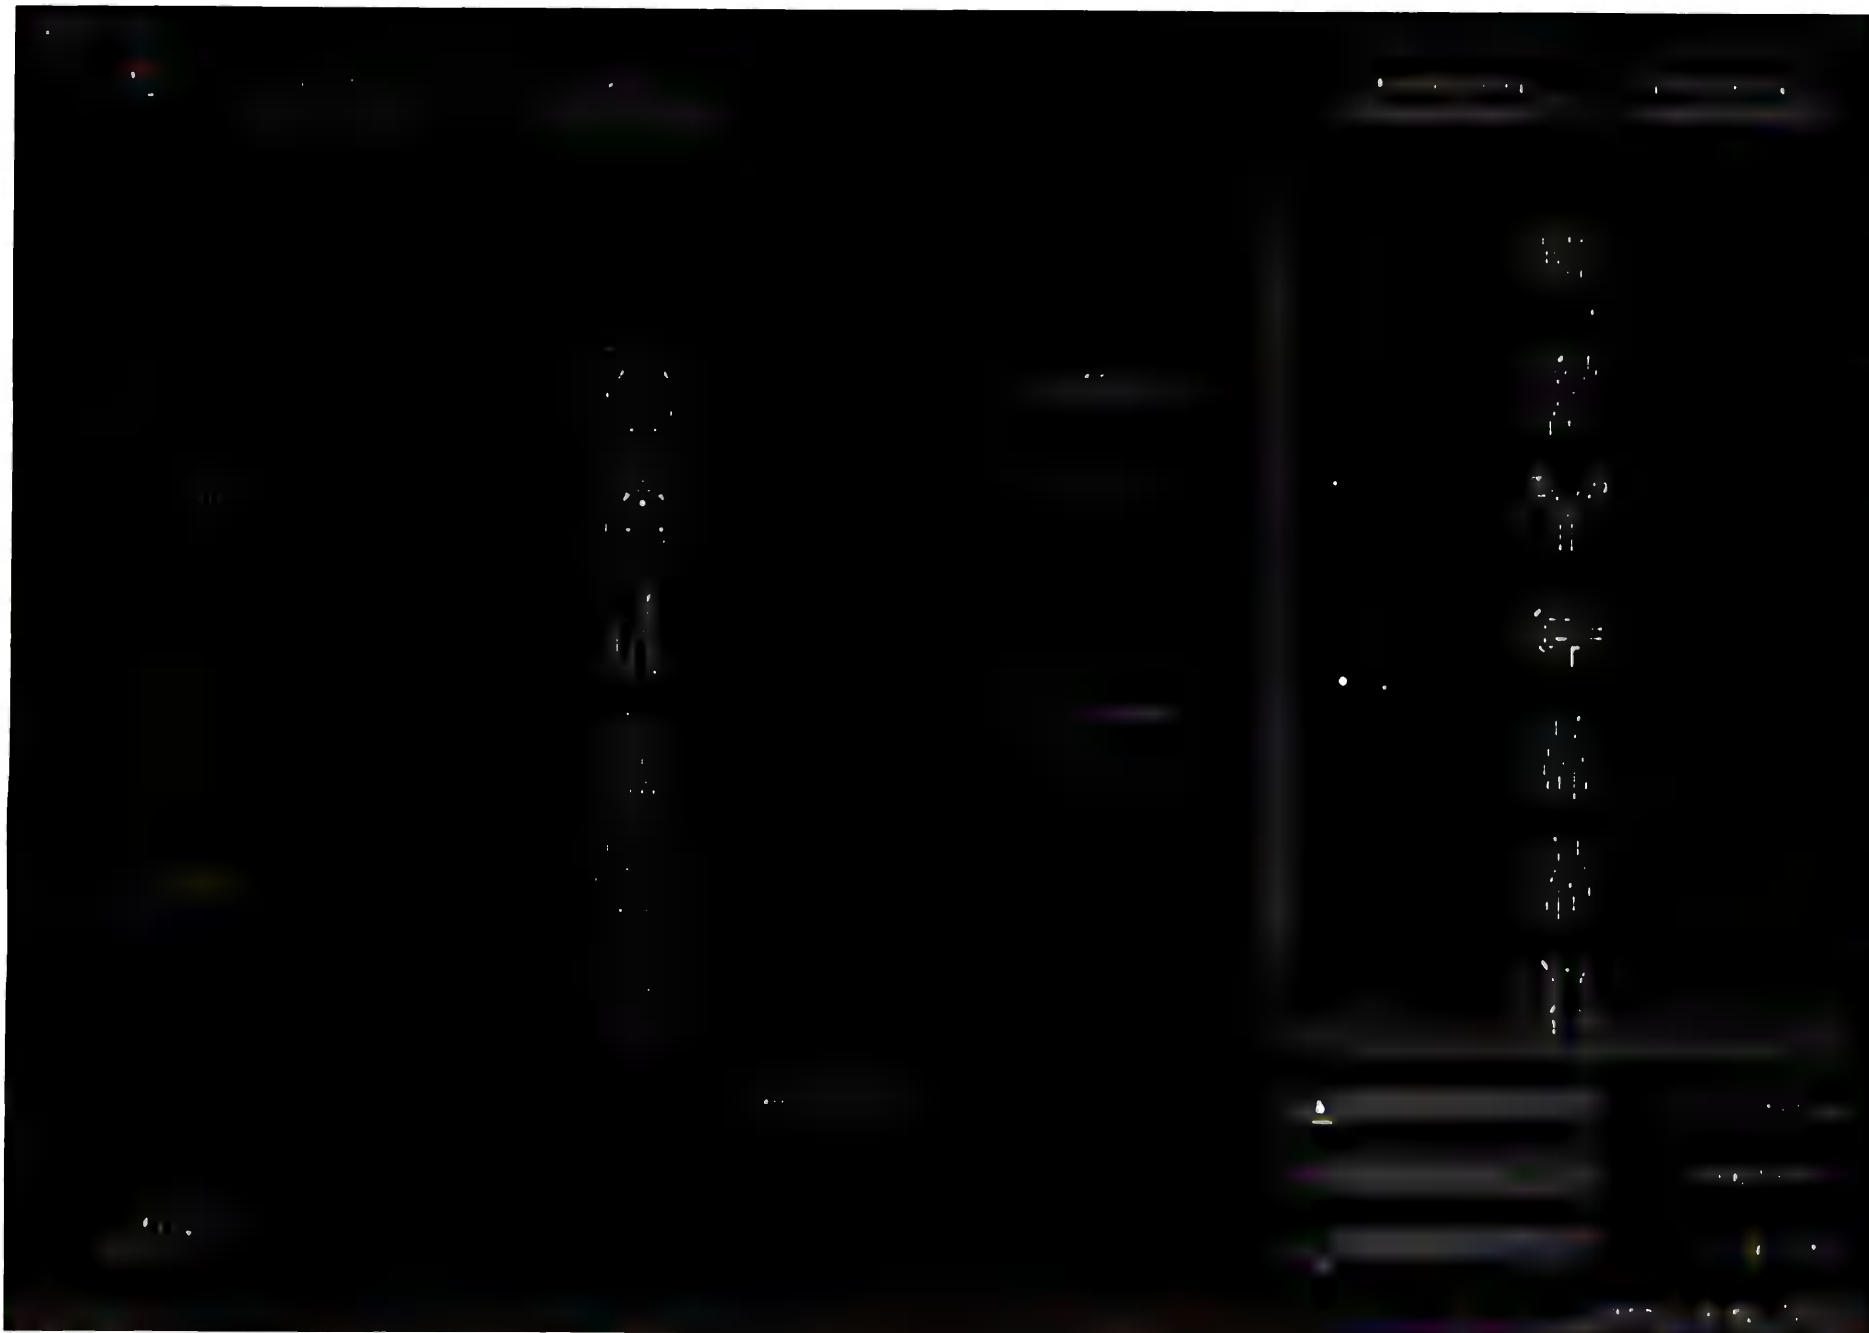

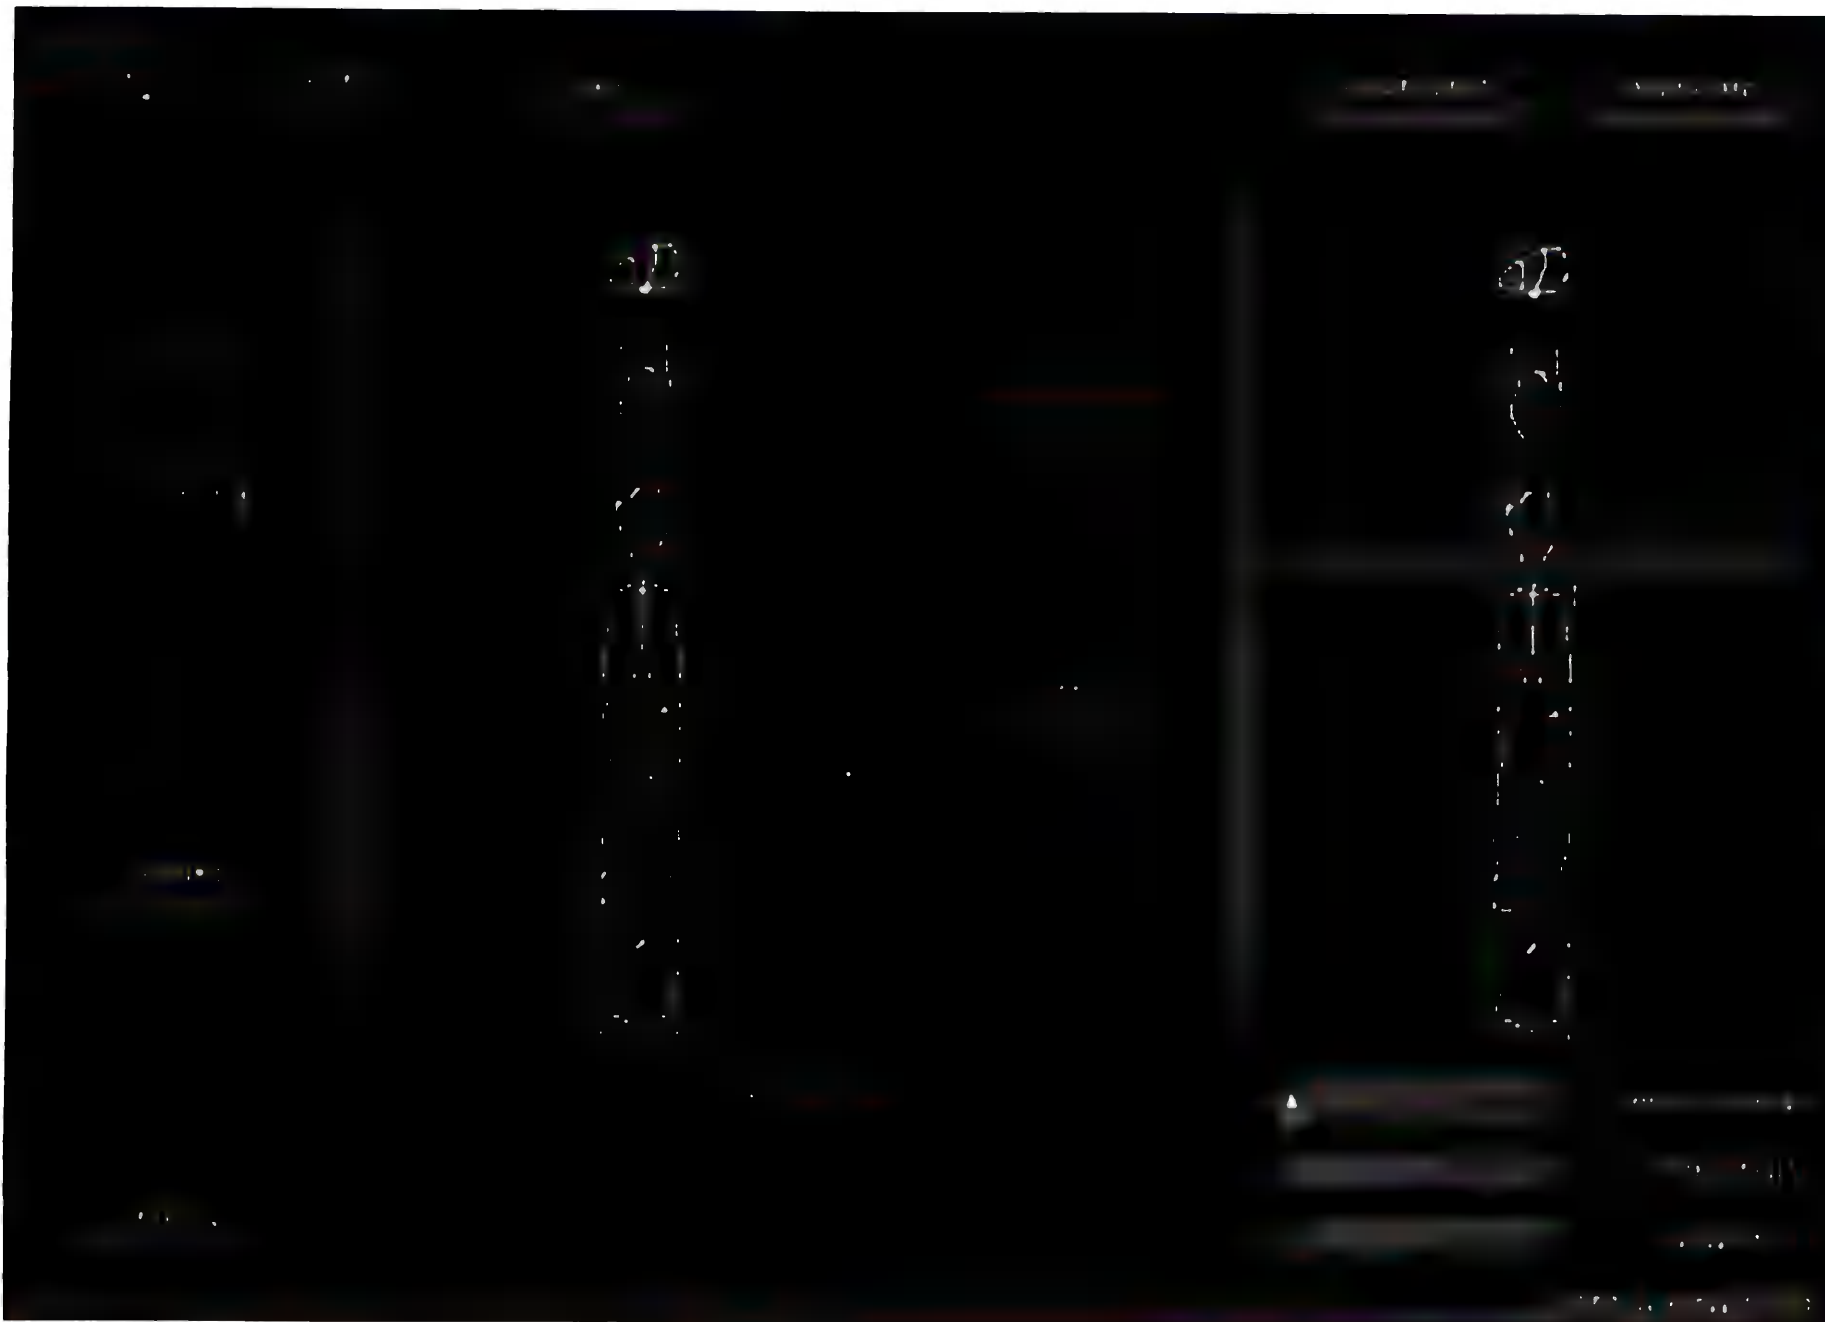

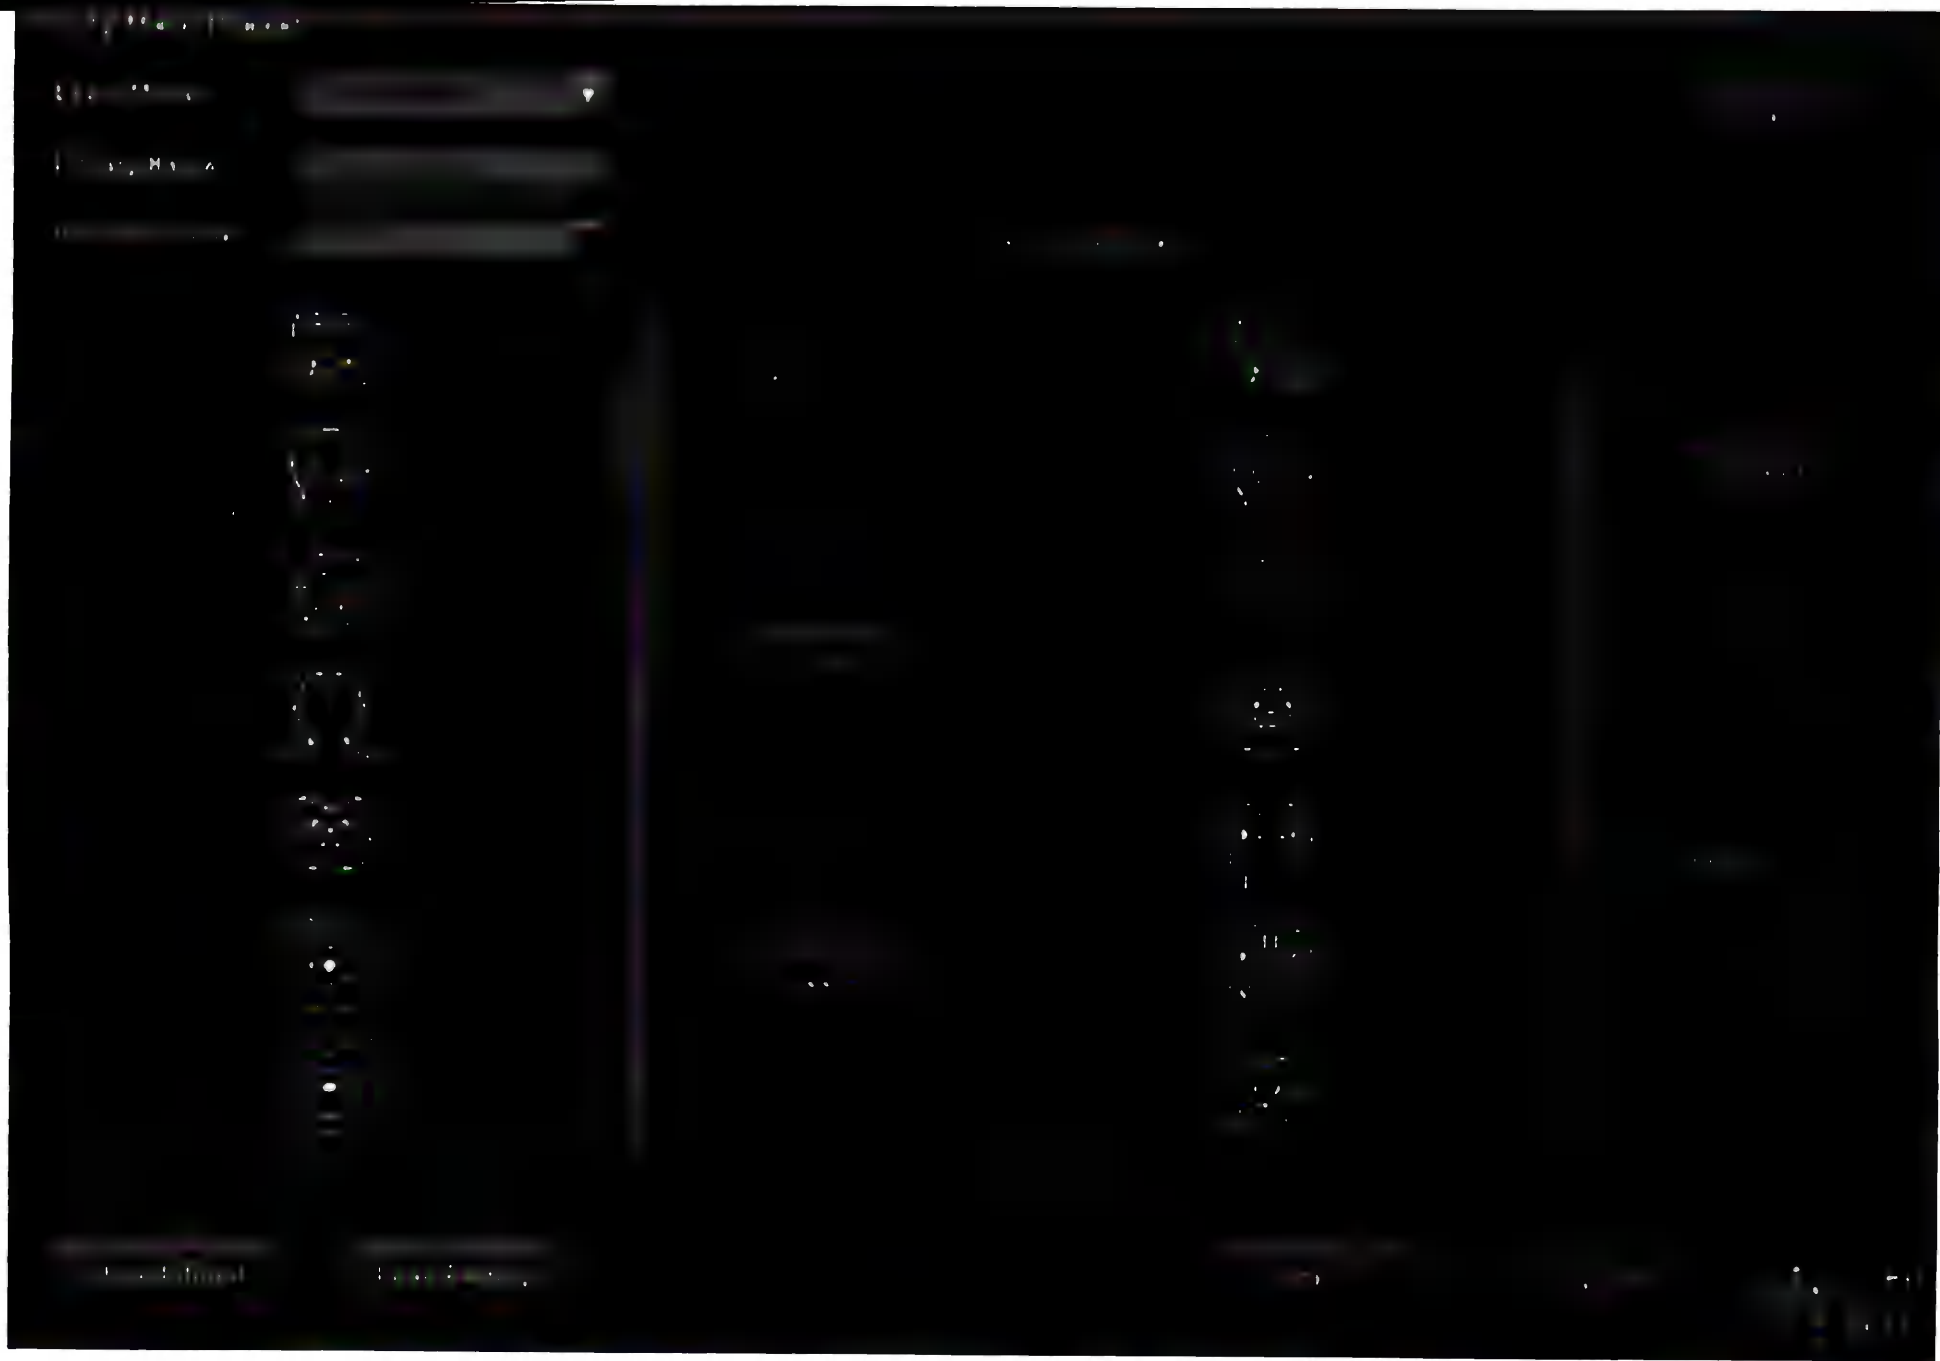



26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate

35

SR Storage Option

Not Store SR

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Storage		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Worklist

AE Title

Port

104

Maximum Retries

1

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Scheduled Station AE Title

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Worklist		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

03:36

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage Print Worklist **MPPS** StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device 12 Service Name 12-MPPS AE Title Port 104

Maximum Retries 3 Interval Time(Sec) 15 Timeout(Sec) 15

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 03:37

26.15. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device 12 Service Name 12-QueryRetrie AE Title Port 104

Maximum Retries 1 Interval Time(Sec) 15 Timeout(Sec) 15

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-QueryRetrieve		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate

35

SR Storage Option

Not Store SR

Add

Cancel

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Not Store SR

Service List

	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

6.17. Для интеграции в большую сеть DICOM: Структурированный отчет (для исследования в формате DICOM Vascular SR)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12

Service Name: 12-Storage

AE Title:

Port: 104

Maximum Retries: 3

Interval Time(Sec): 15

Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original

Compression Mode: RLE

Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add

Cancel

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Not Store SR

Service List

	Device		Default
1	12	12-Storage	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device 12 Service Name 12-Storage AE Title Port 104

Maximum Retries 3 Interval Time(Sec) 15 Timeout(Sec) 15

Cine Zoom Mode Original Compression Mode RLE Compression Ratio Lossless

Color Mode Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate 35

SR Storage Option Not Store SR

Add Cancel

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List


	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete Default Verify Verification is required!


Exit

EN 02:33

26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)

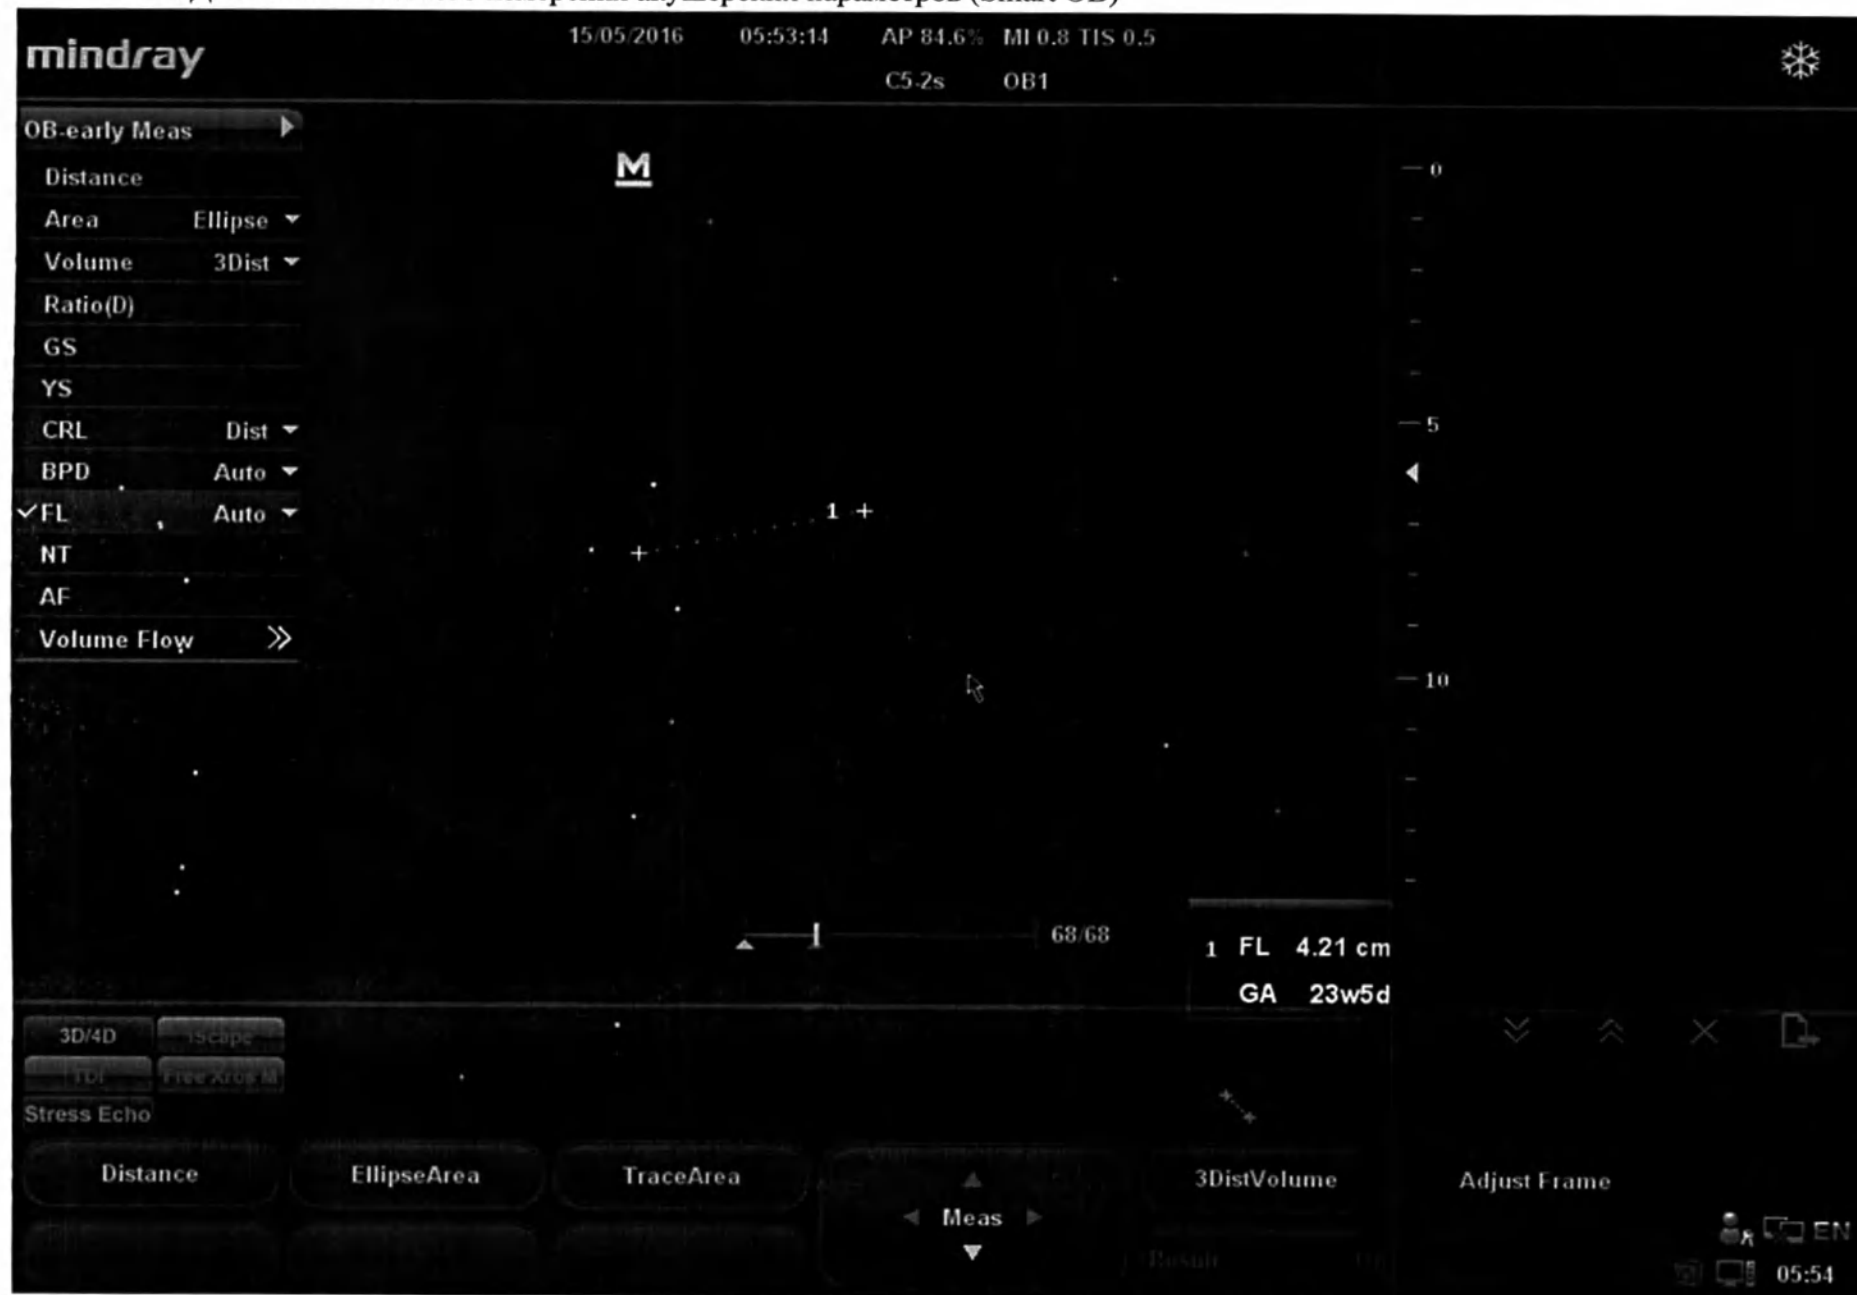

26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)

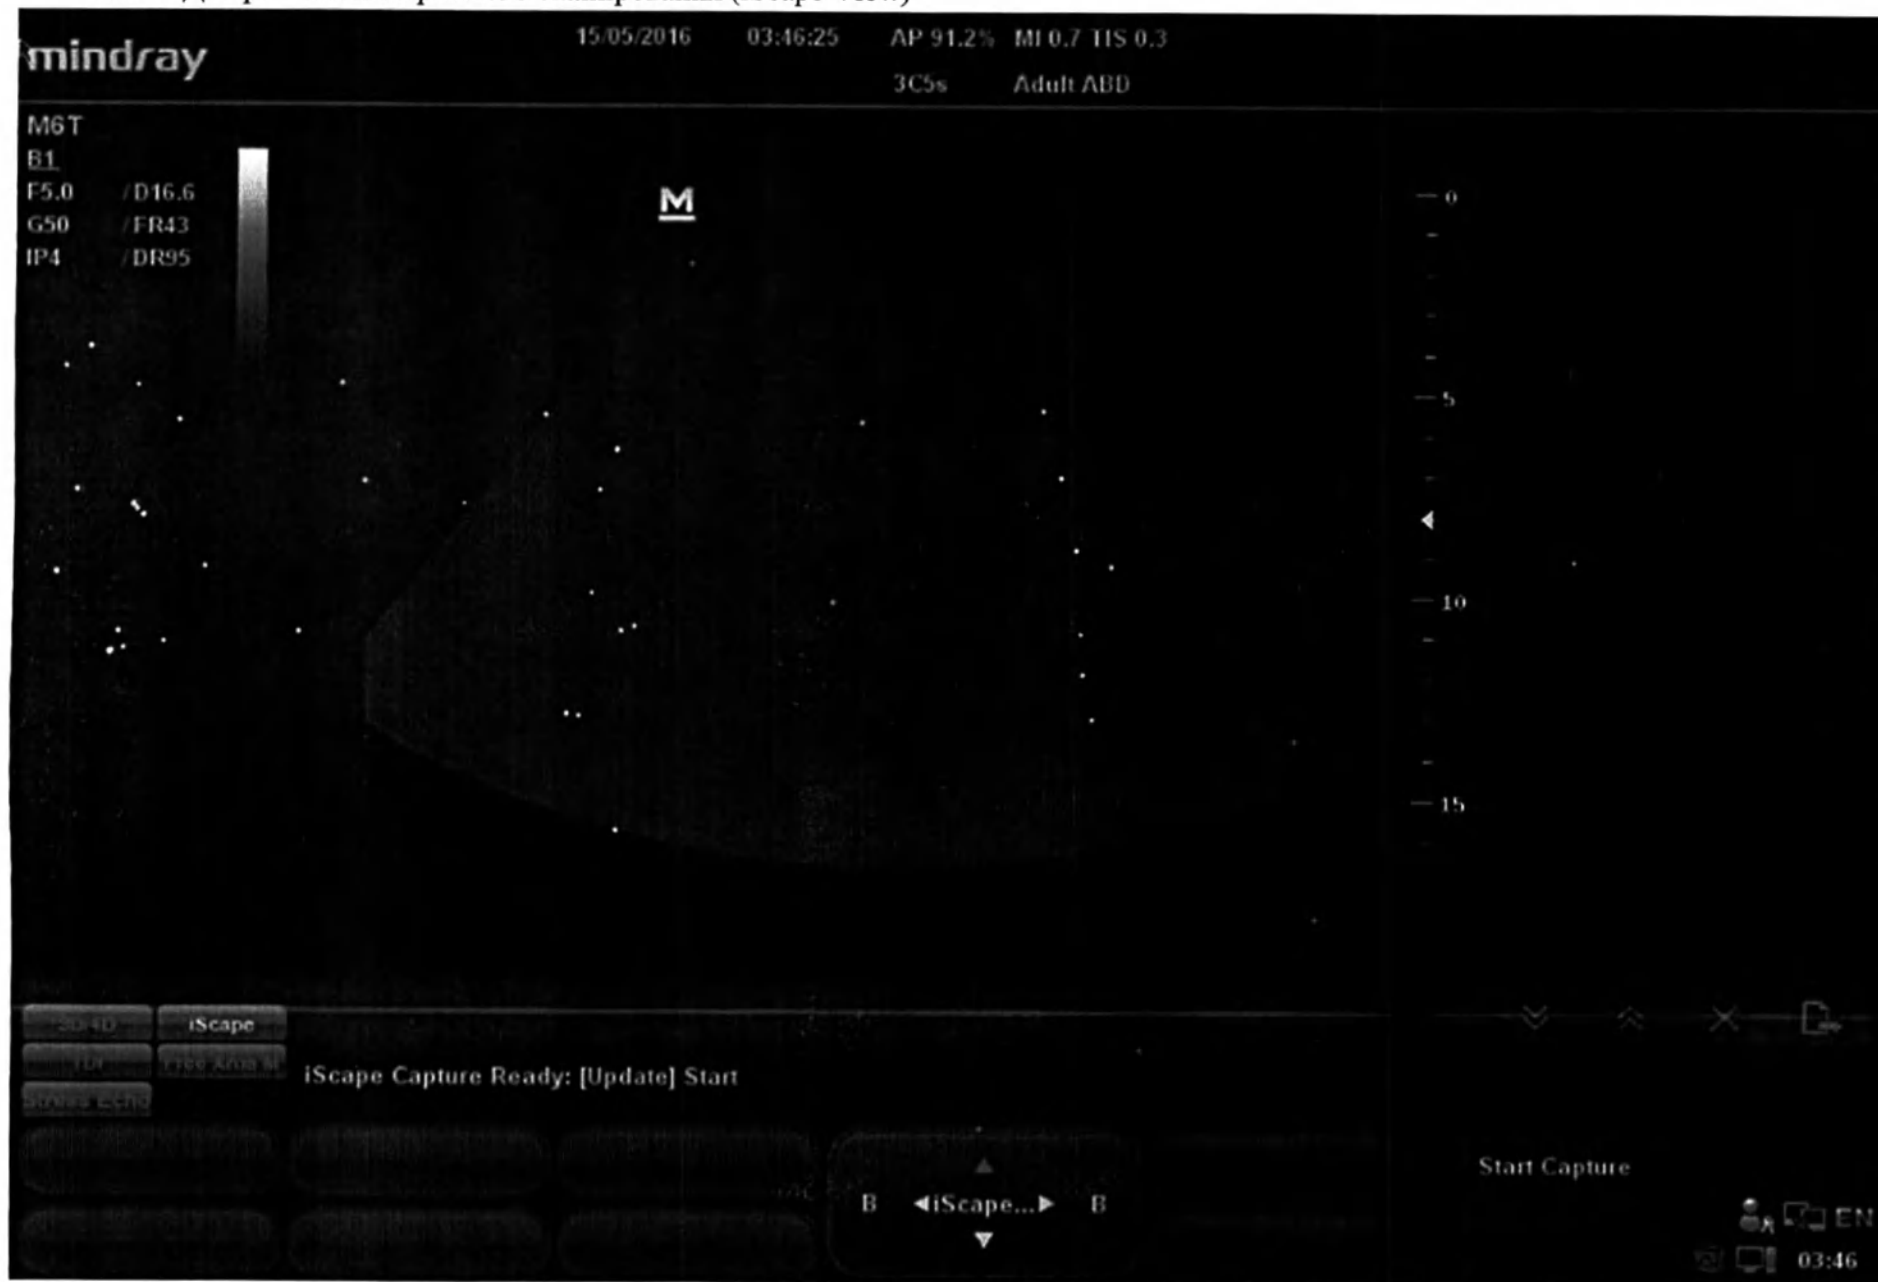

26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)




26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)



26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)



26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)

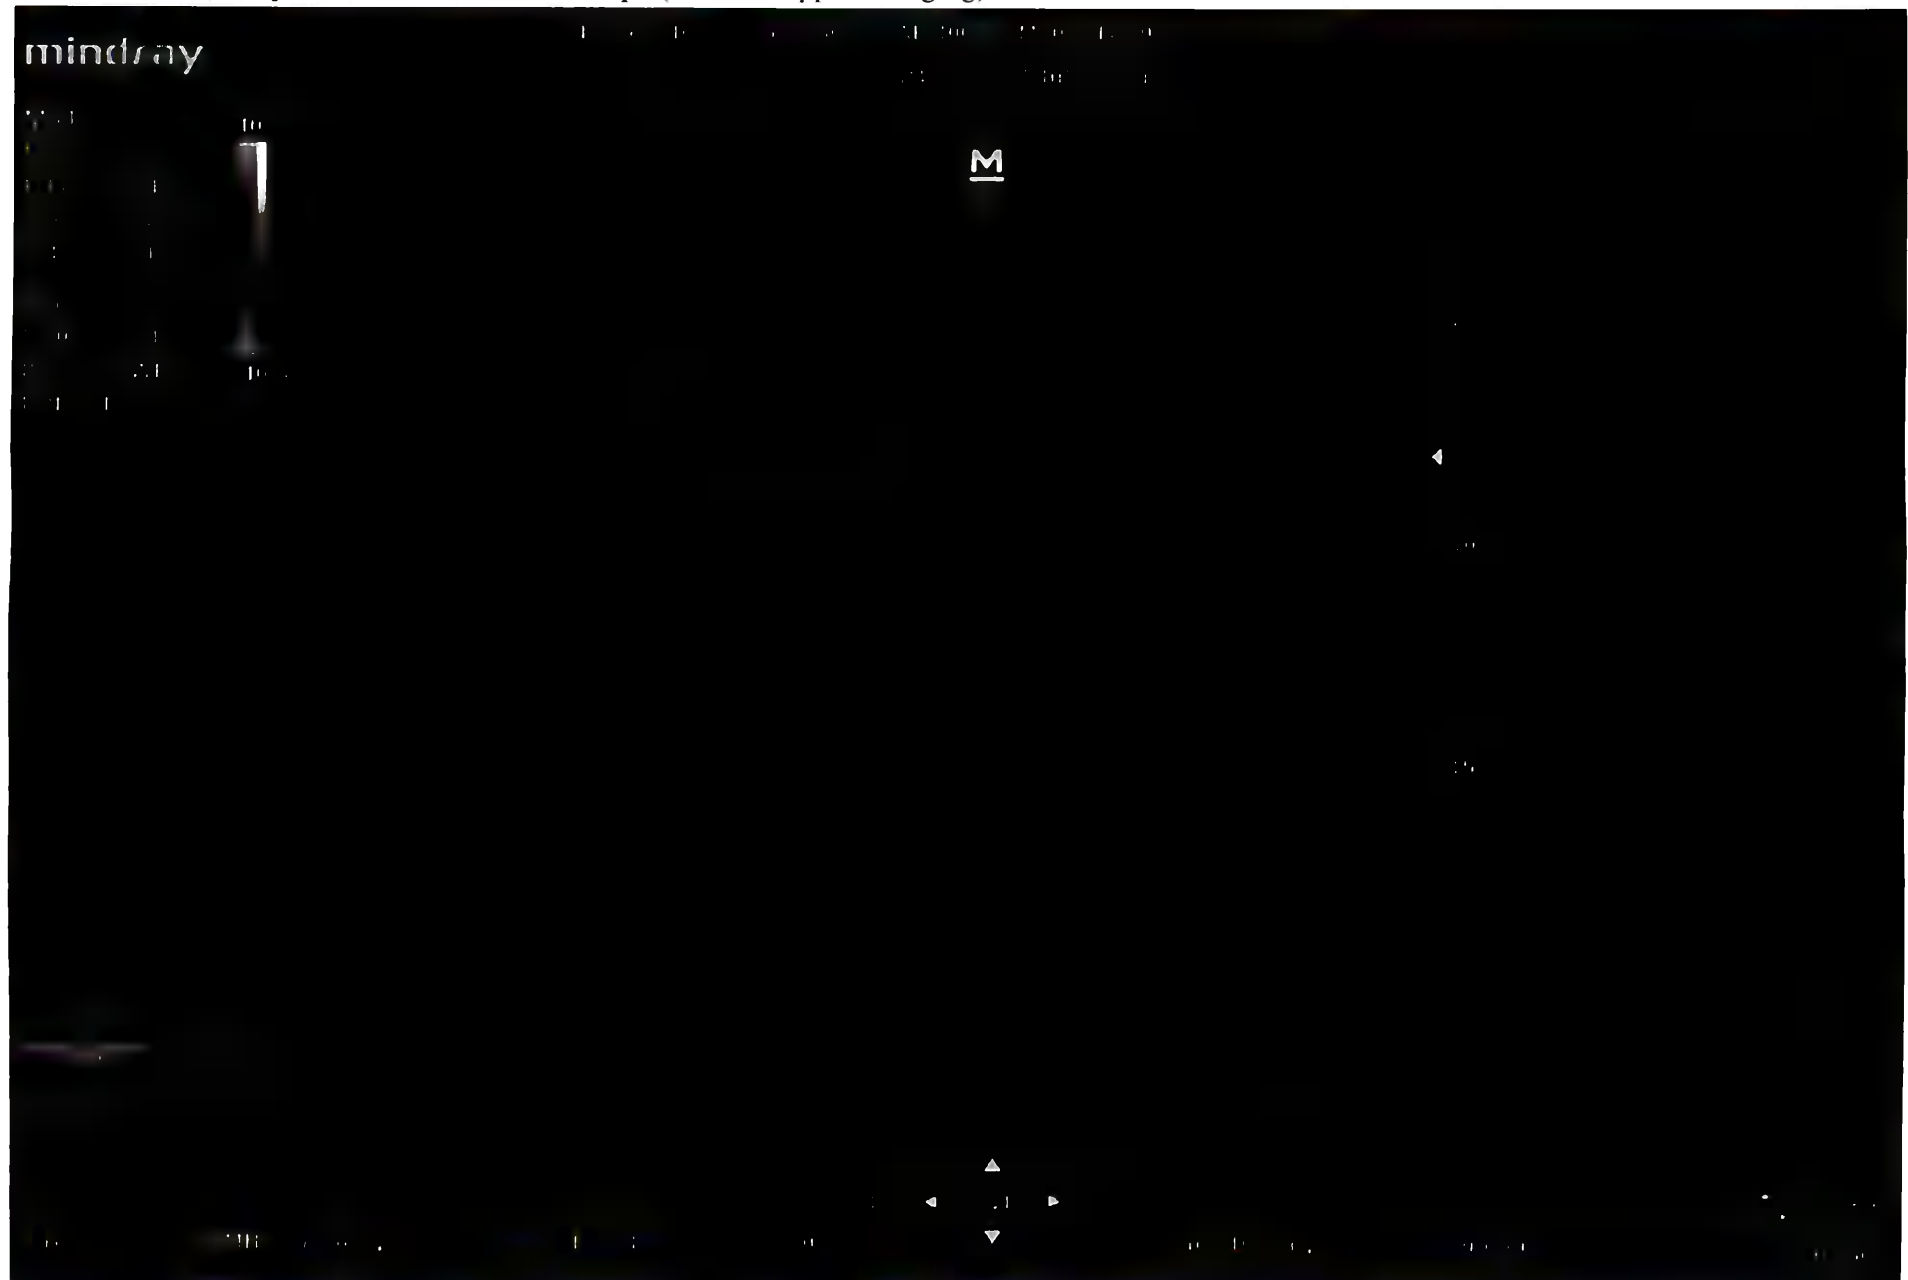




26.26. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo)



26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)

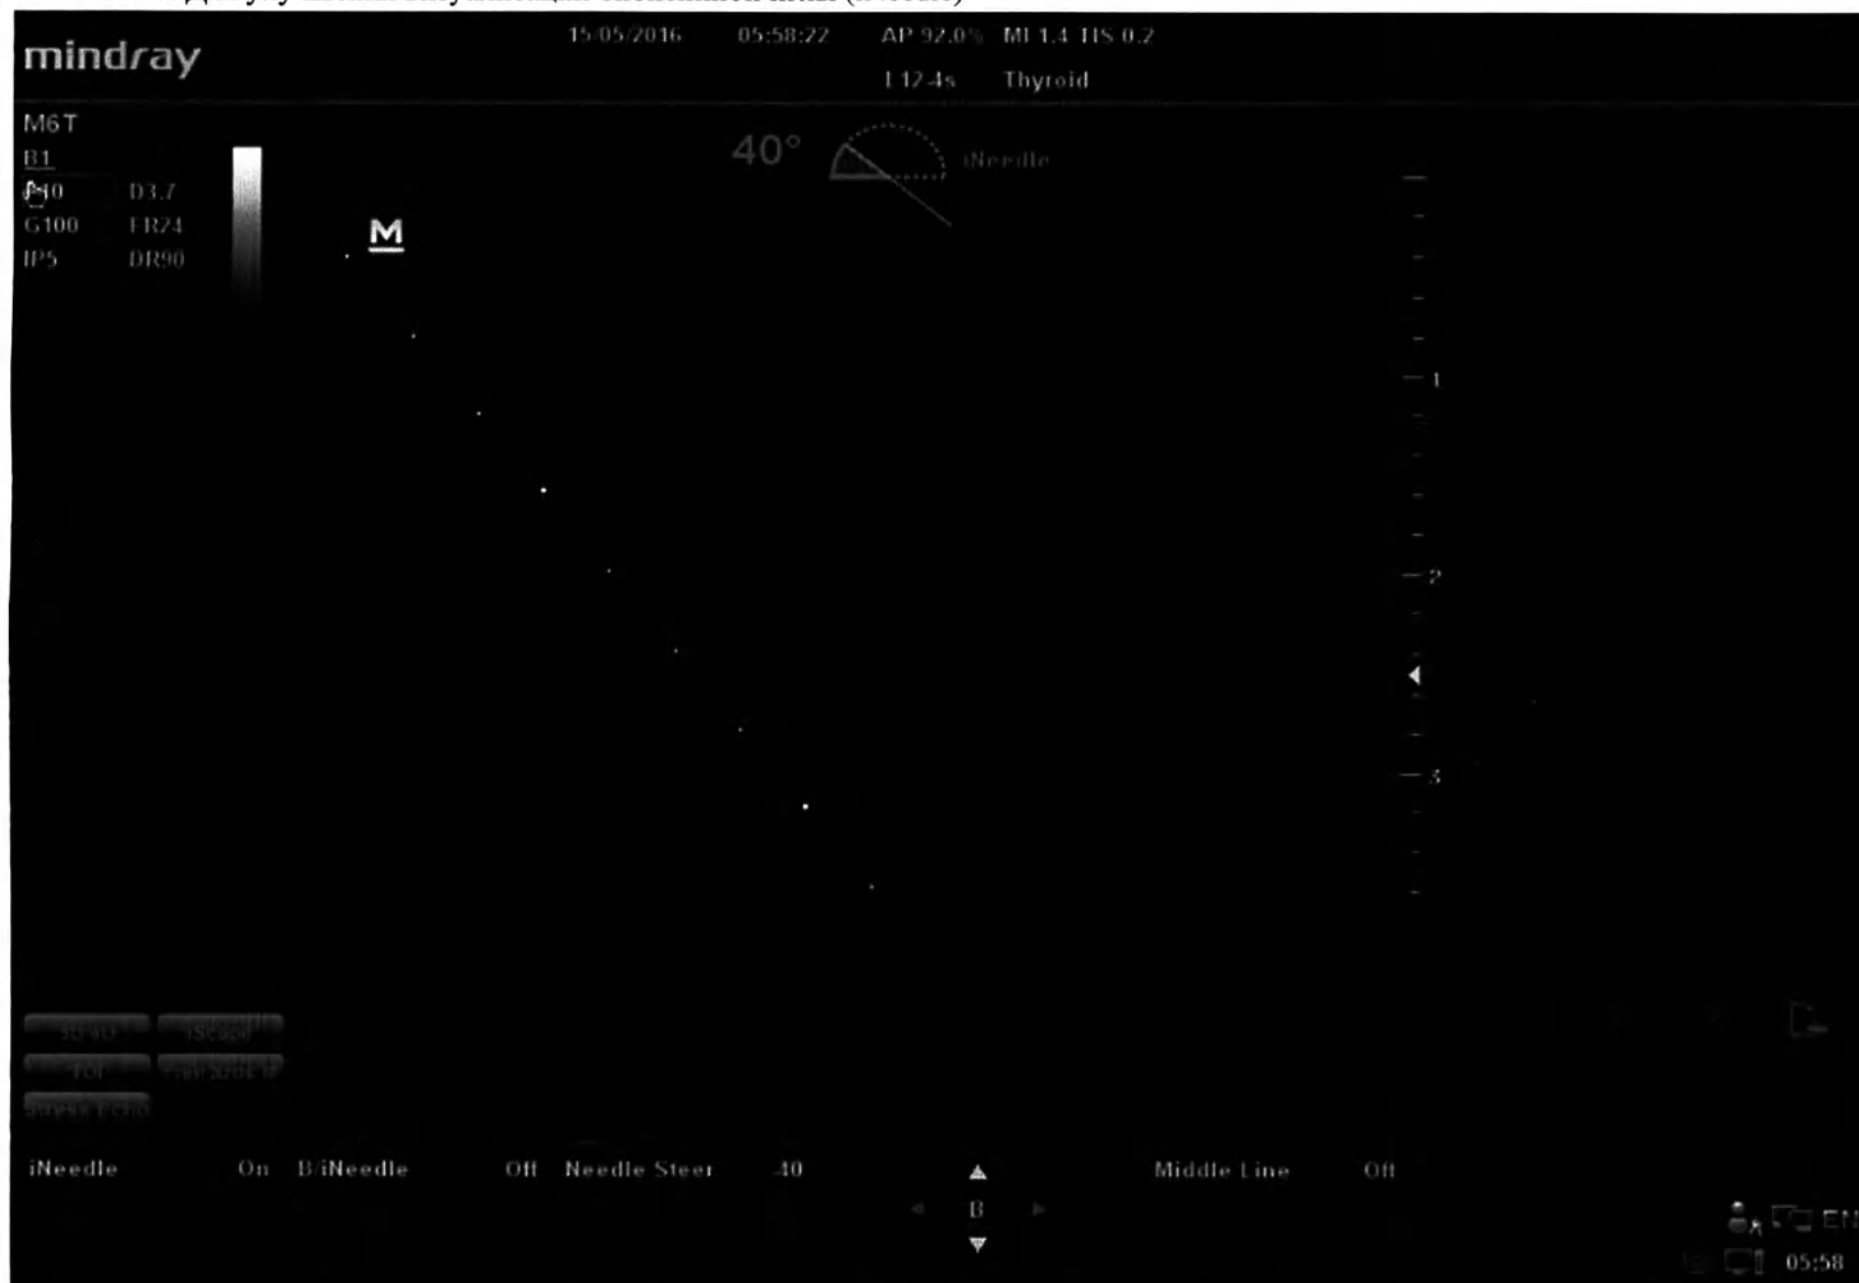


26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)




26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)



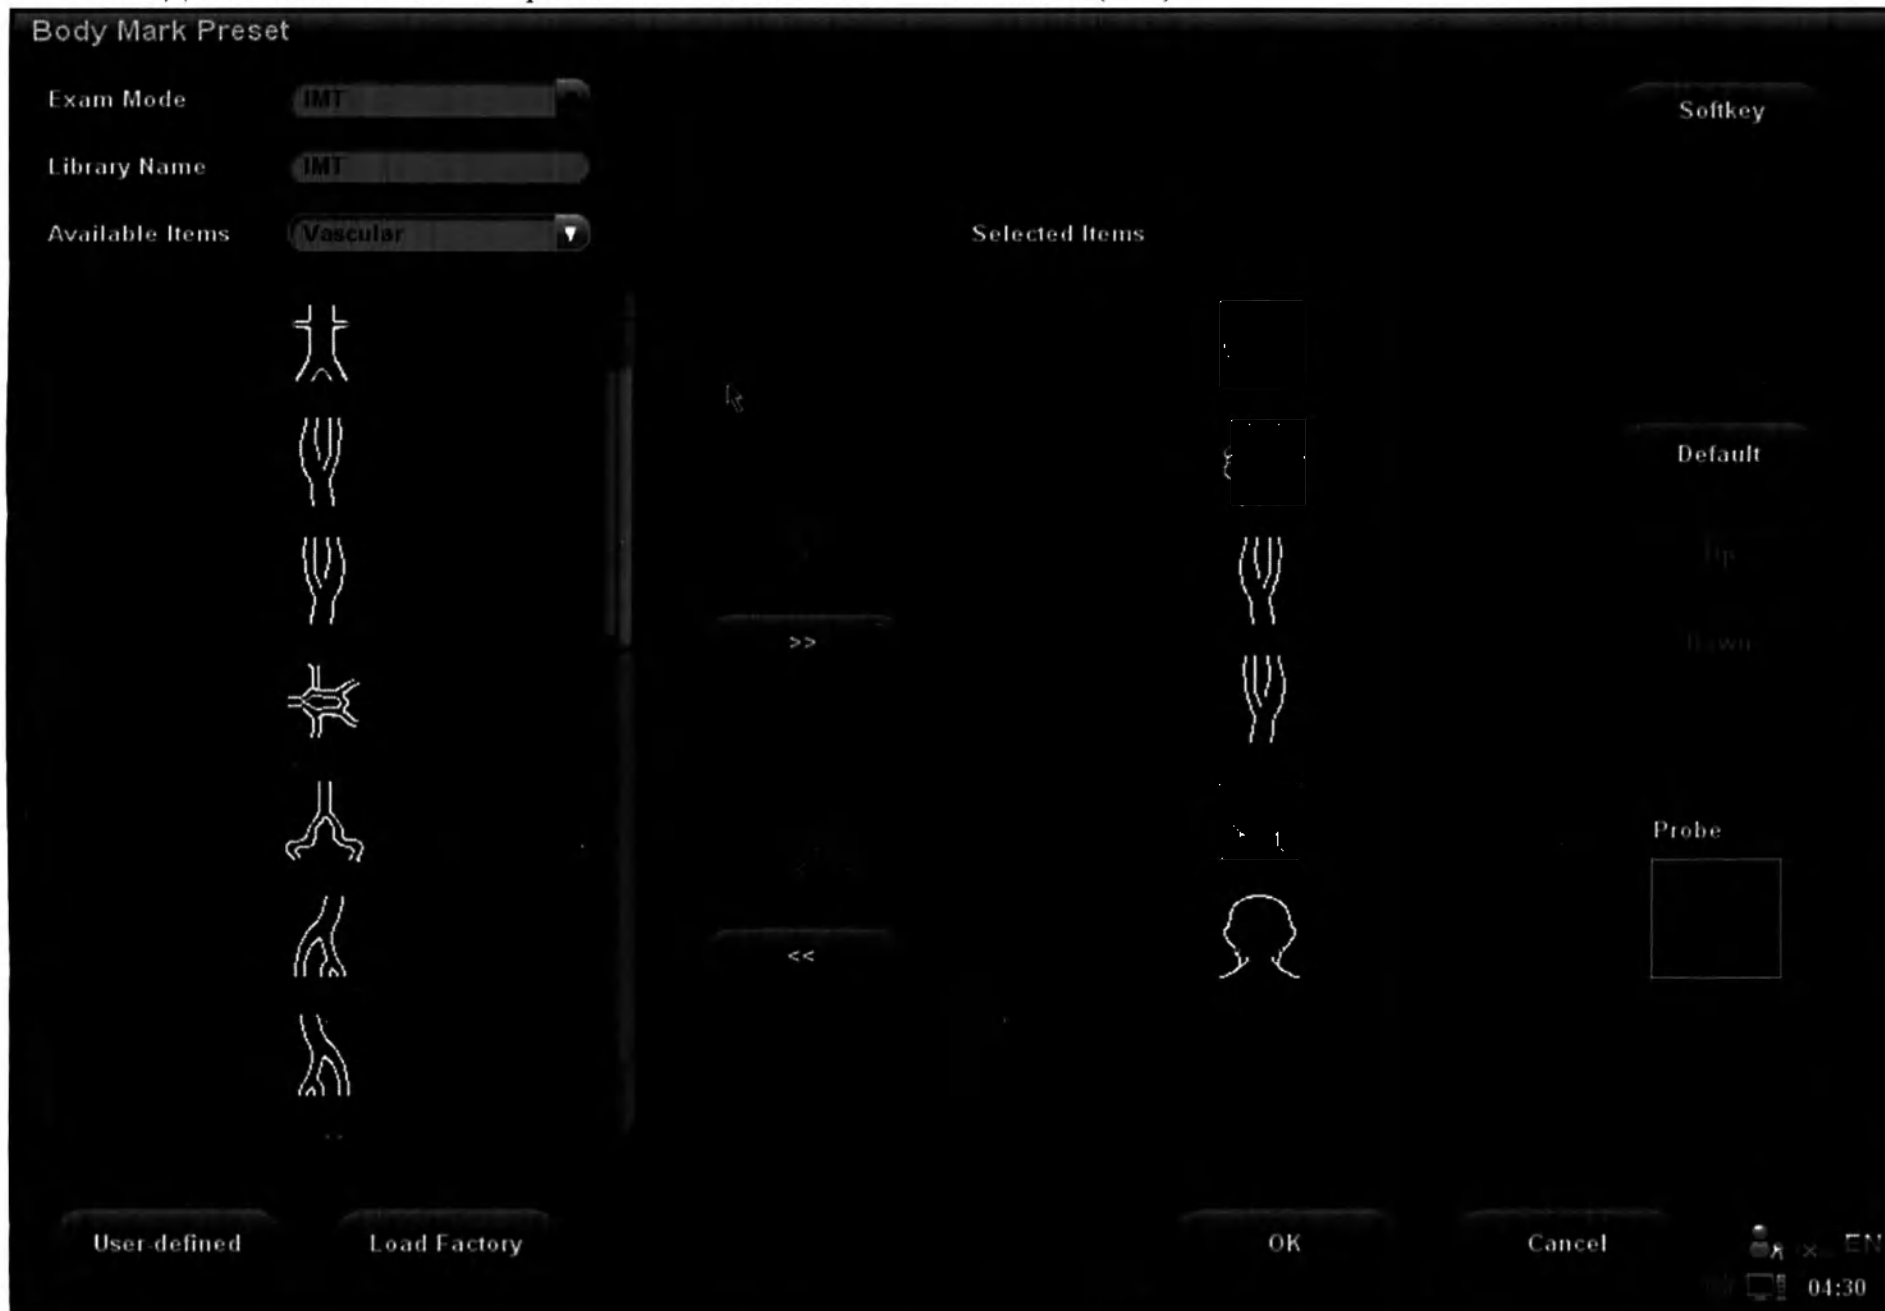


26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

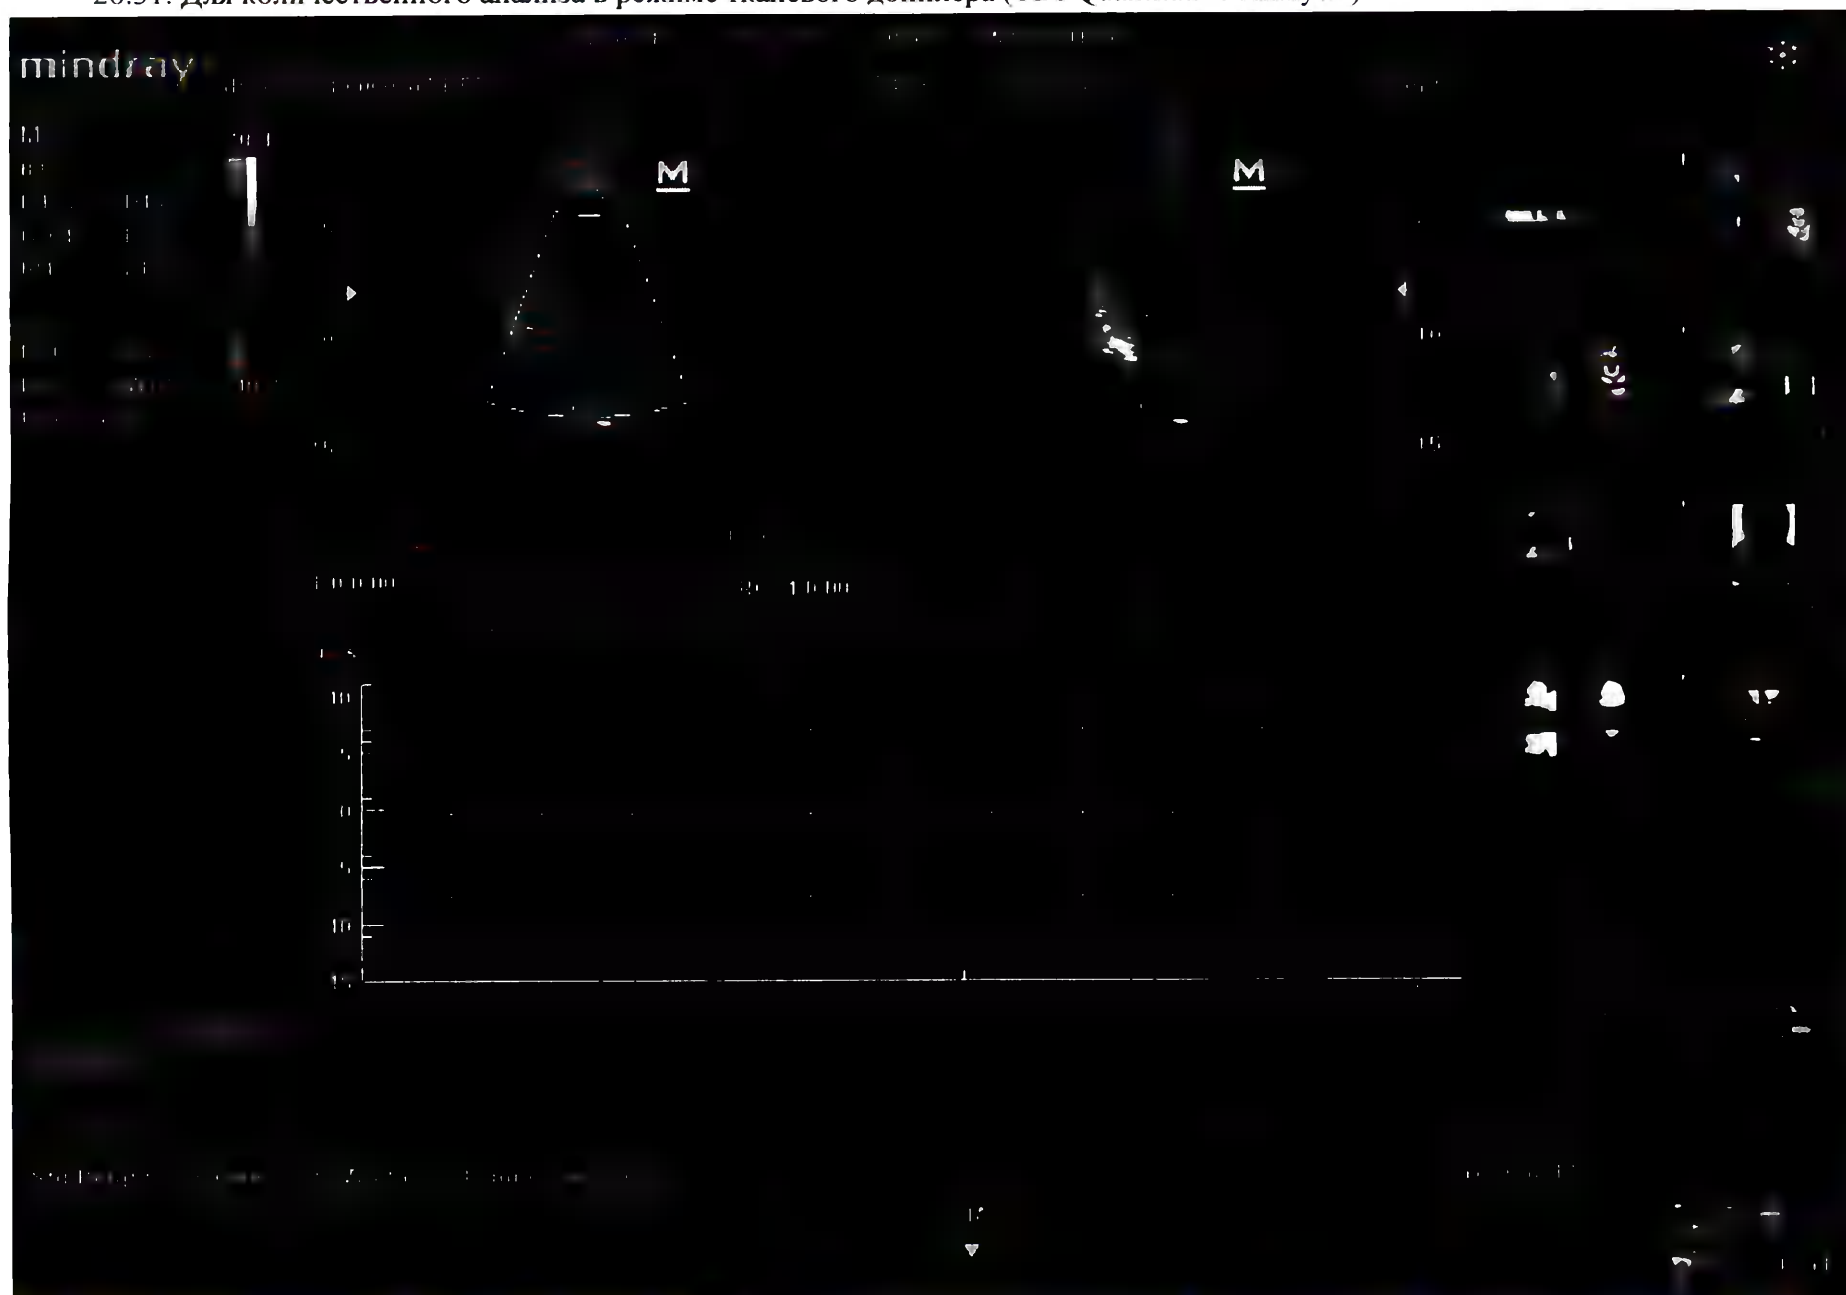



27. Модули:

27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

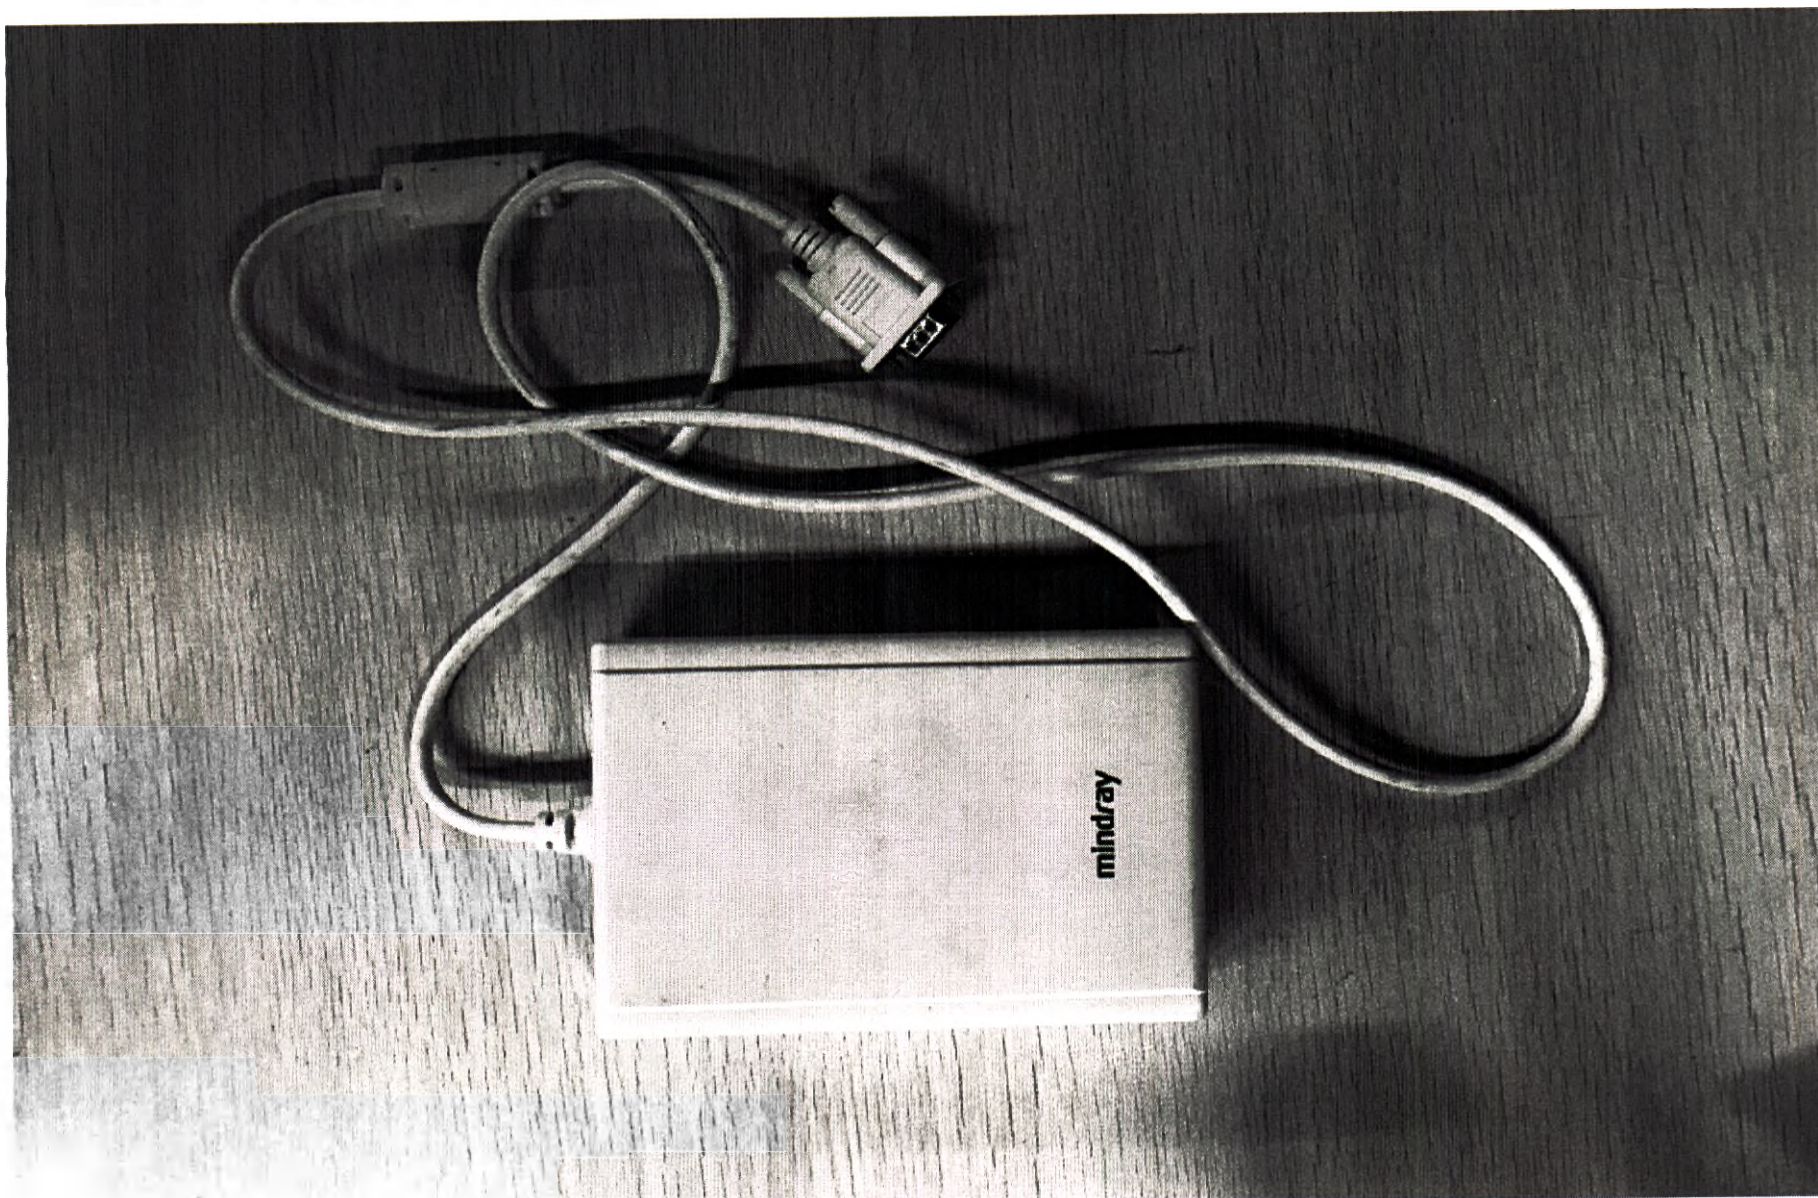




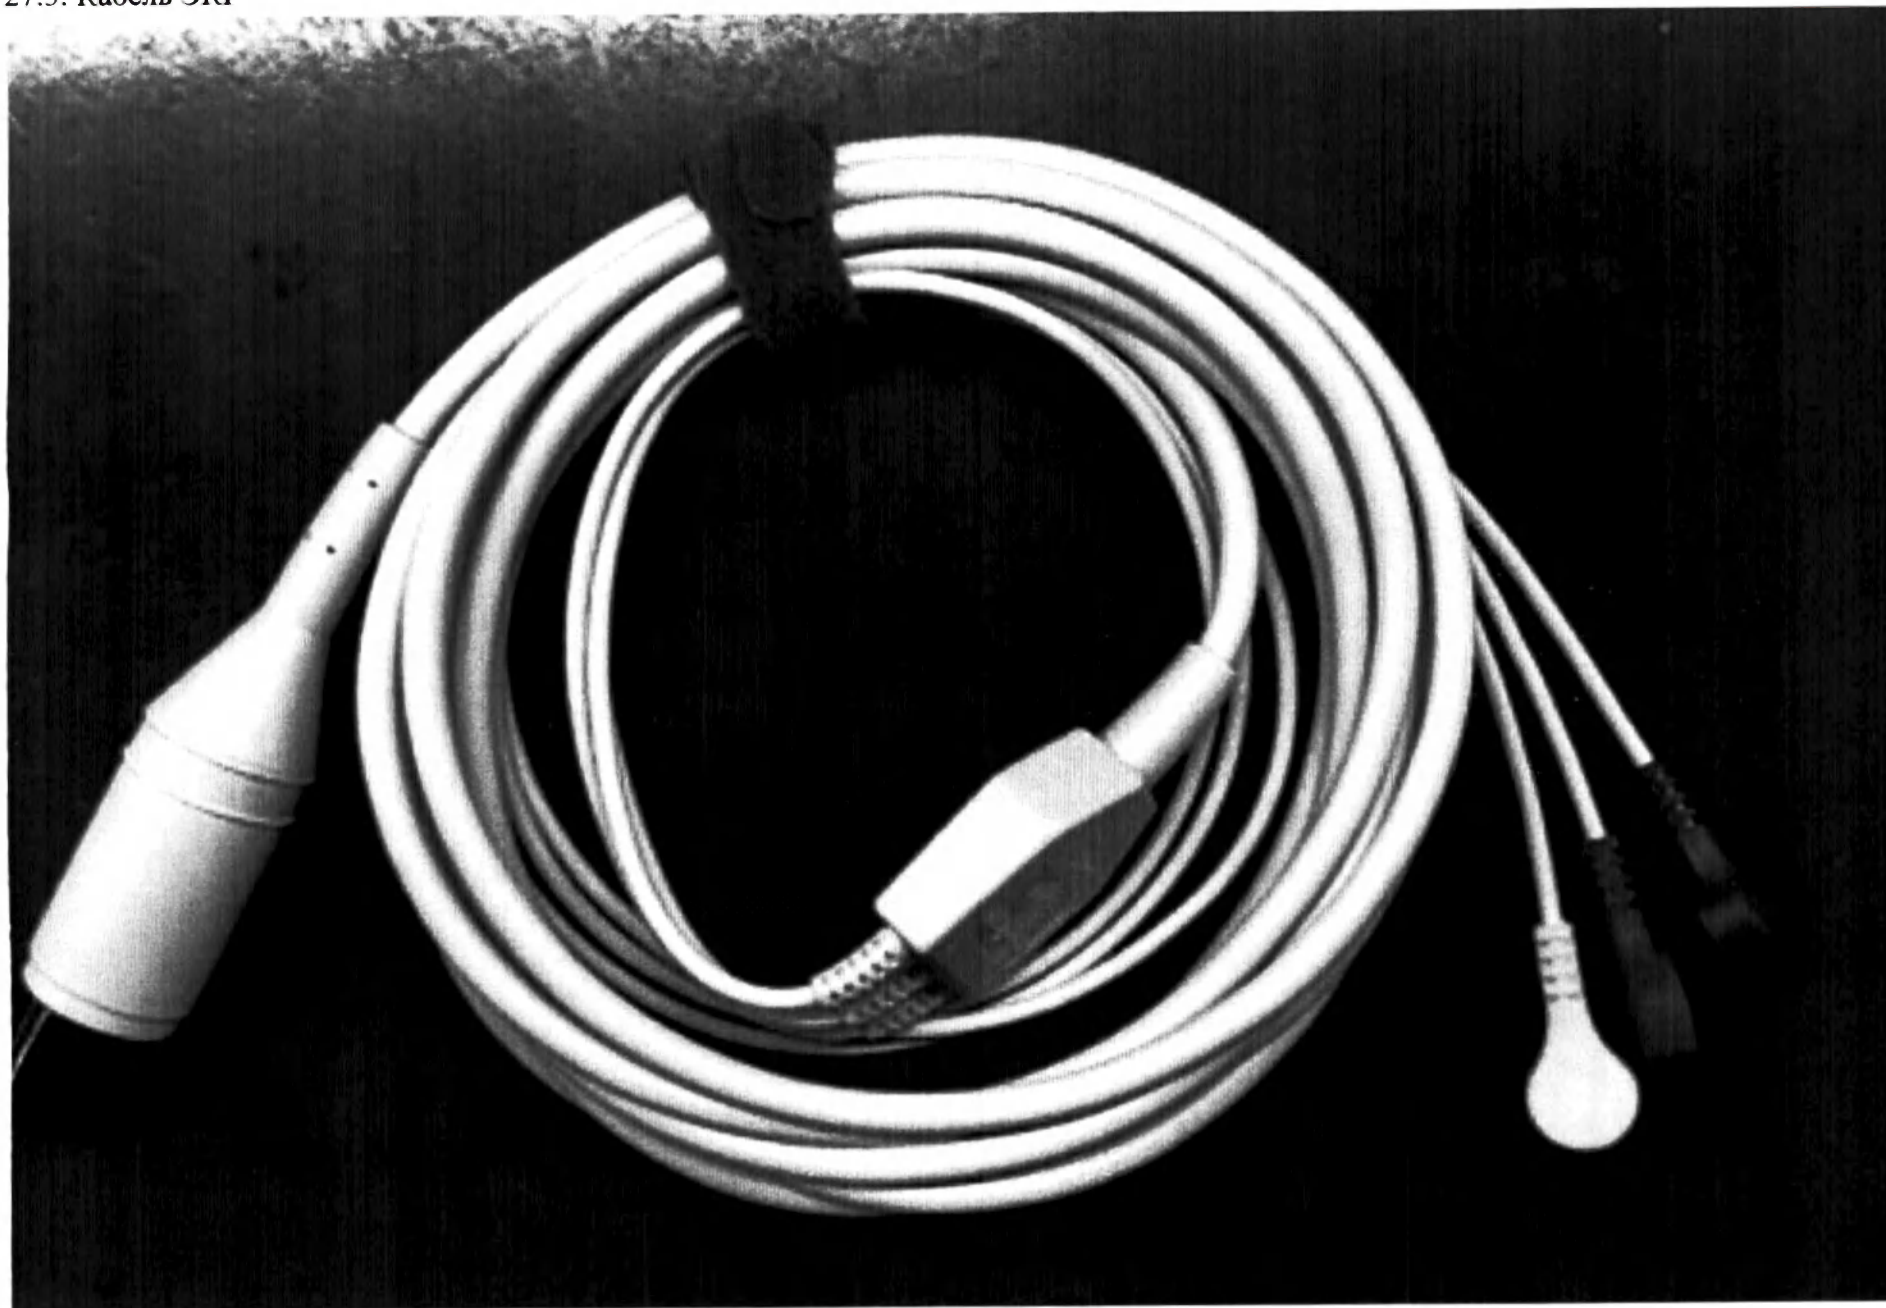

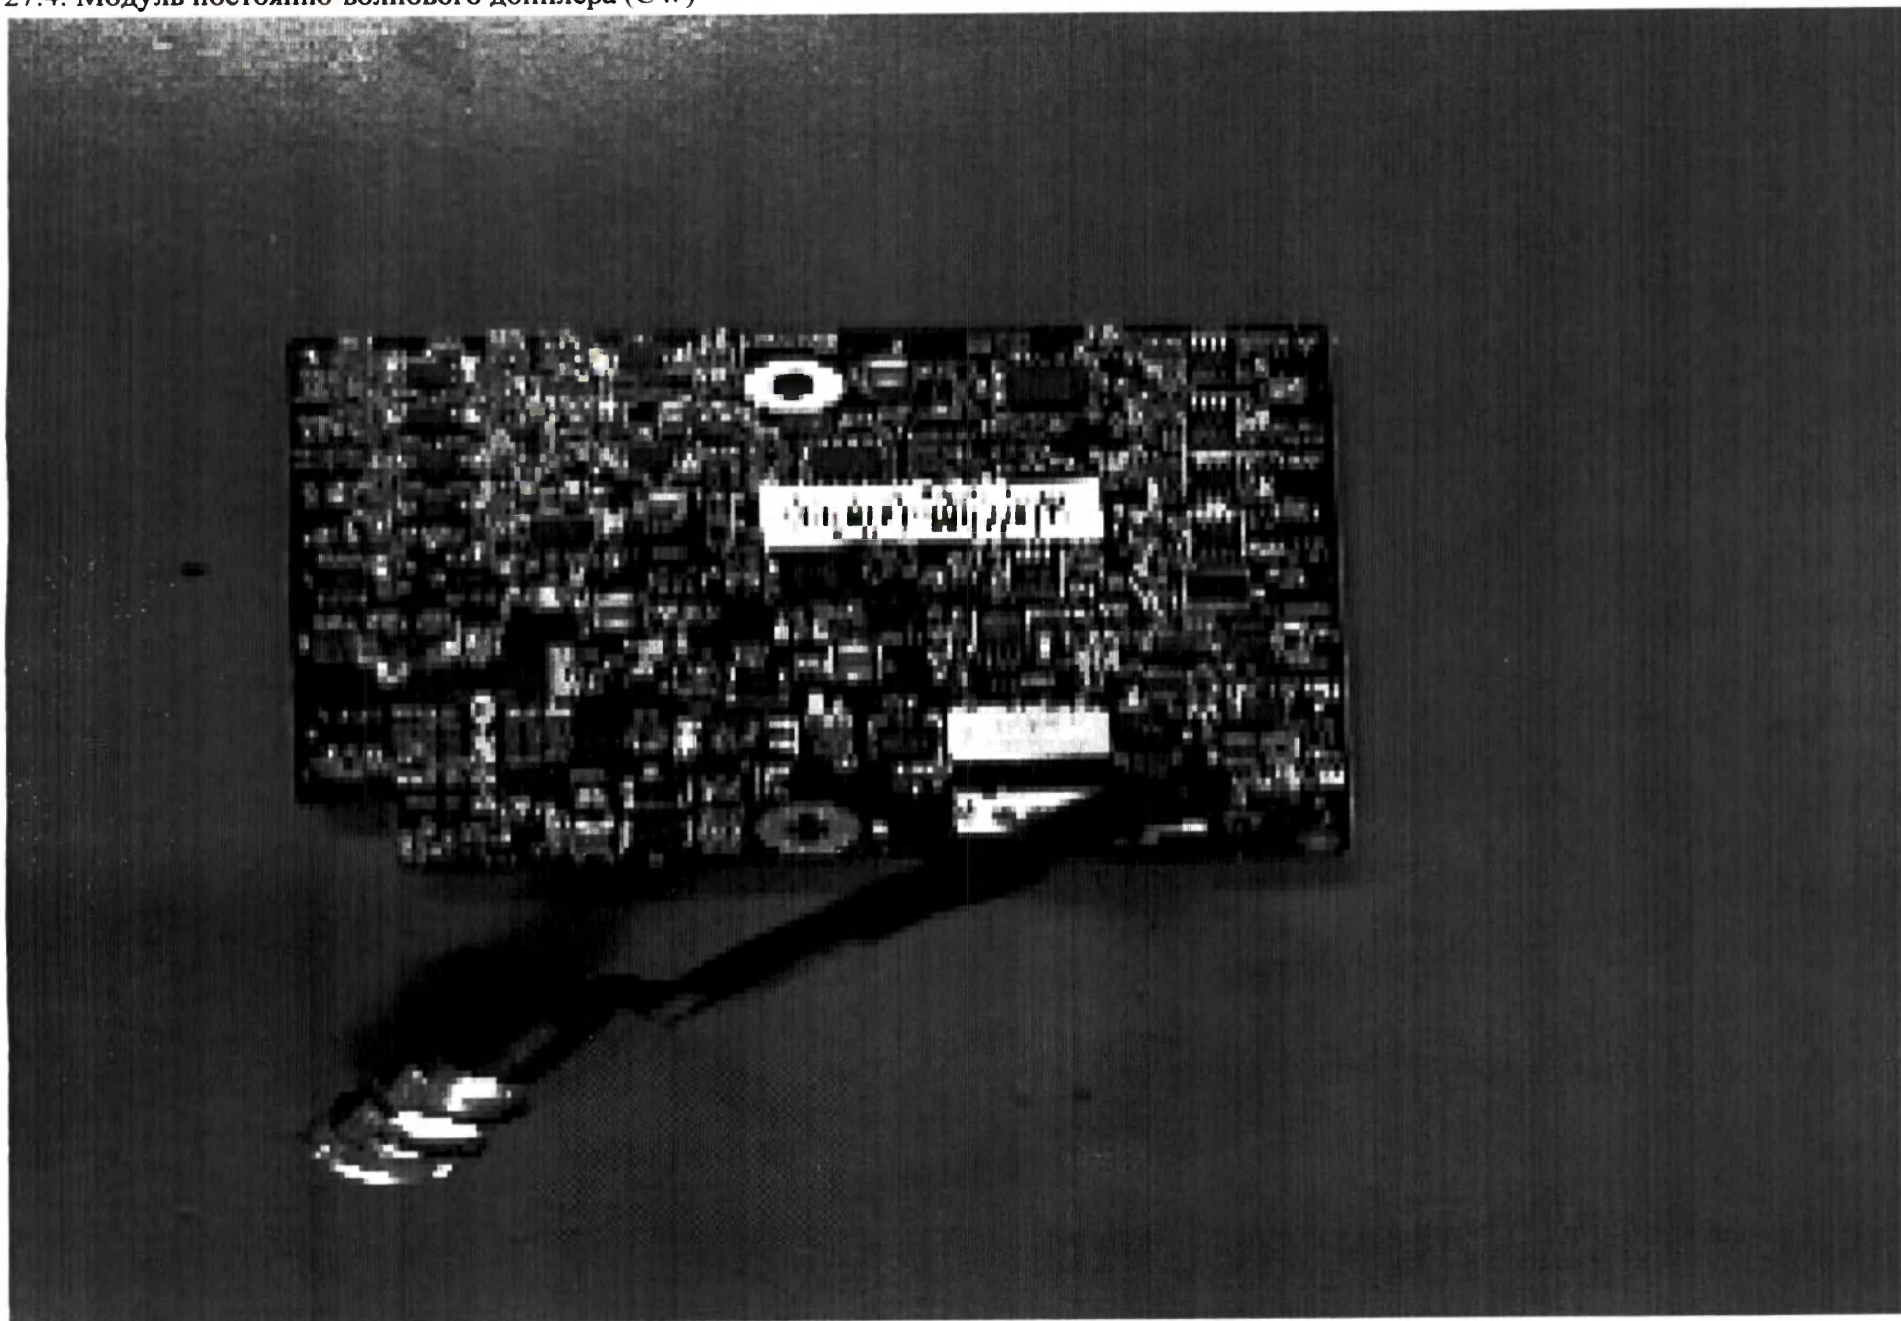



27.5. Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D/TEE Assembly)

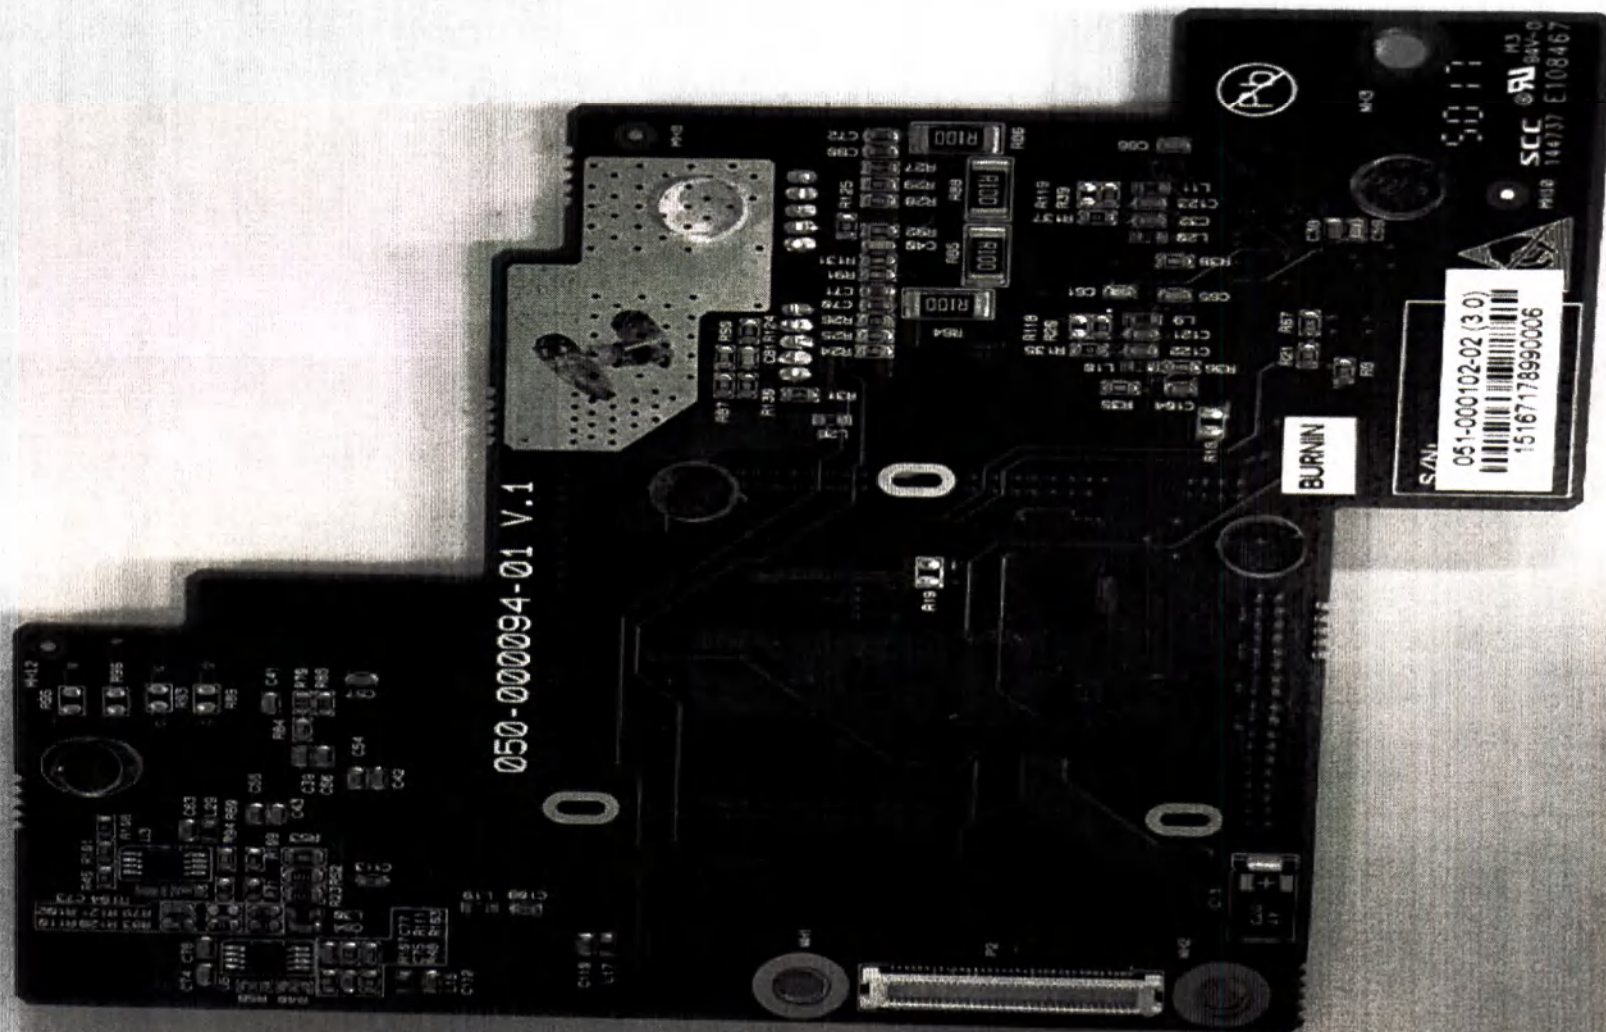



28. Тележки

28. 1. Тележка мобильная UMT-300

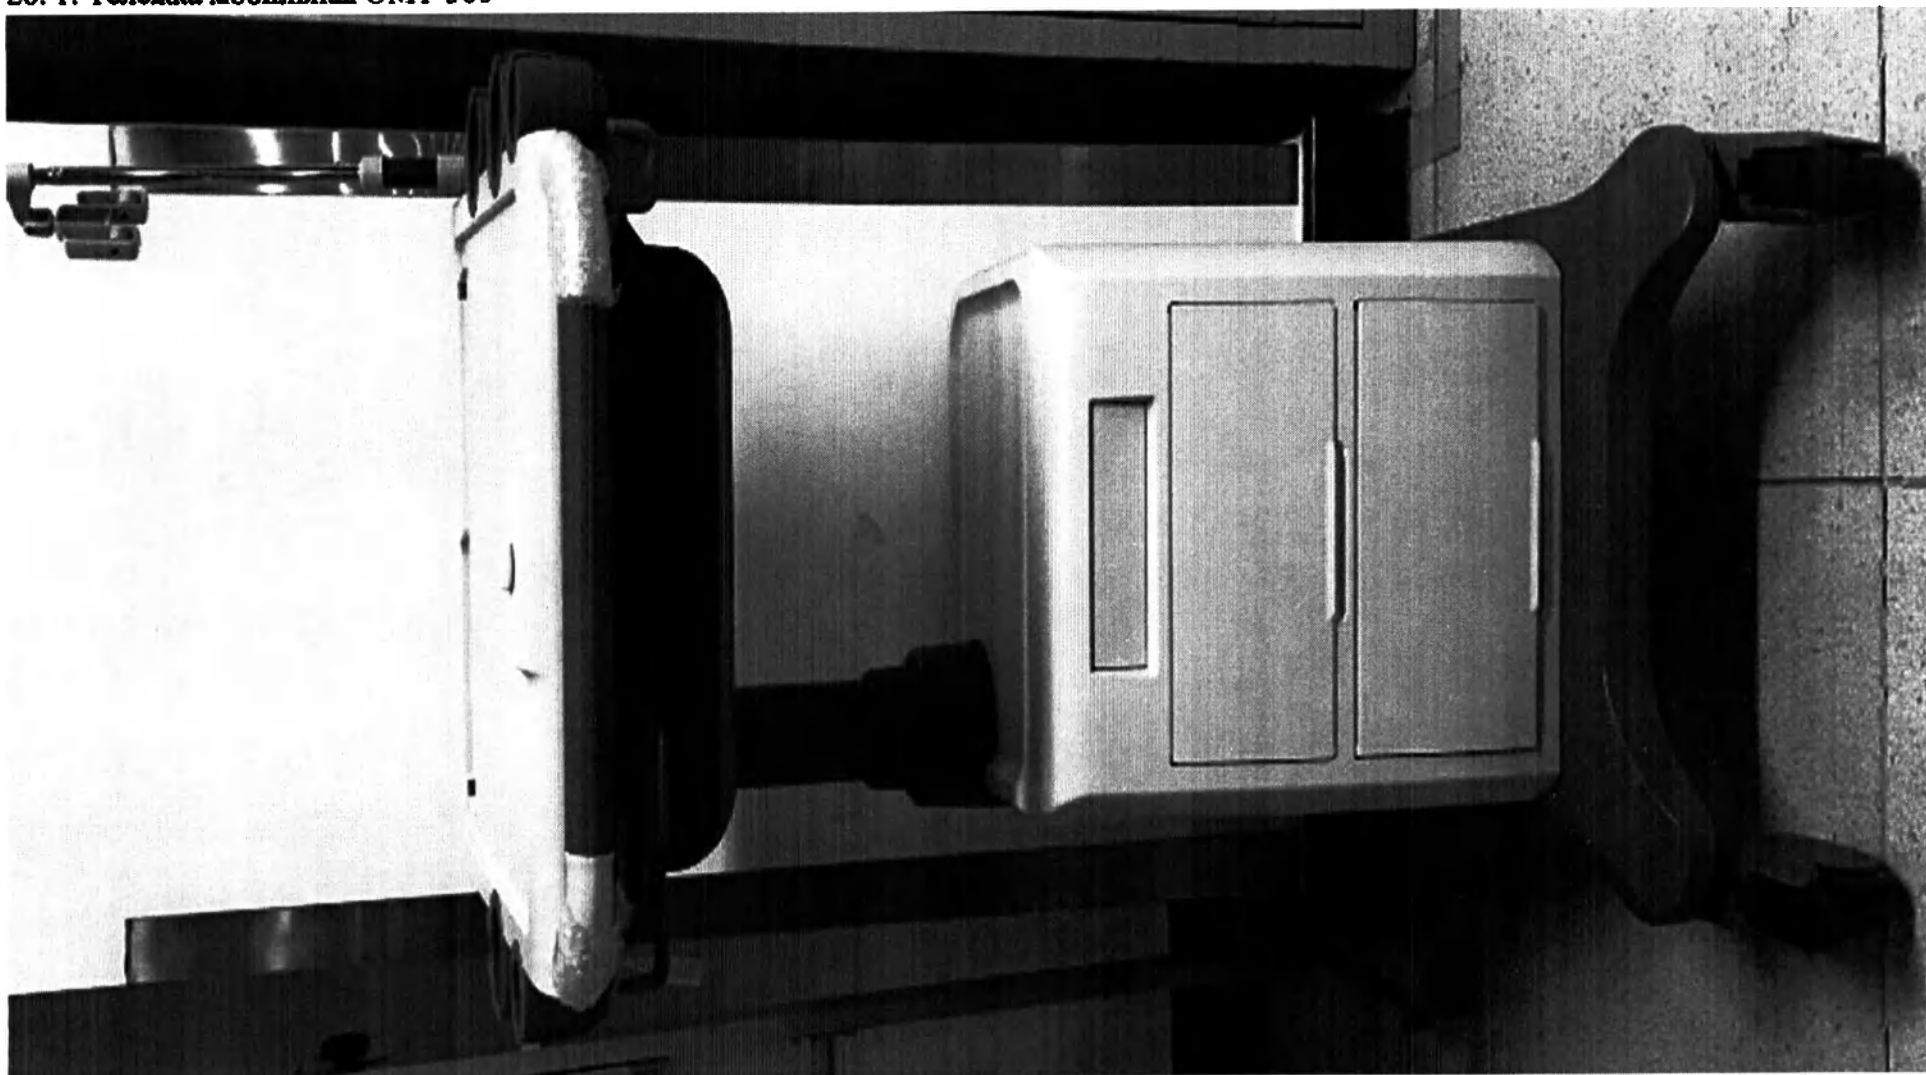

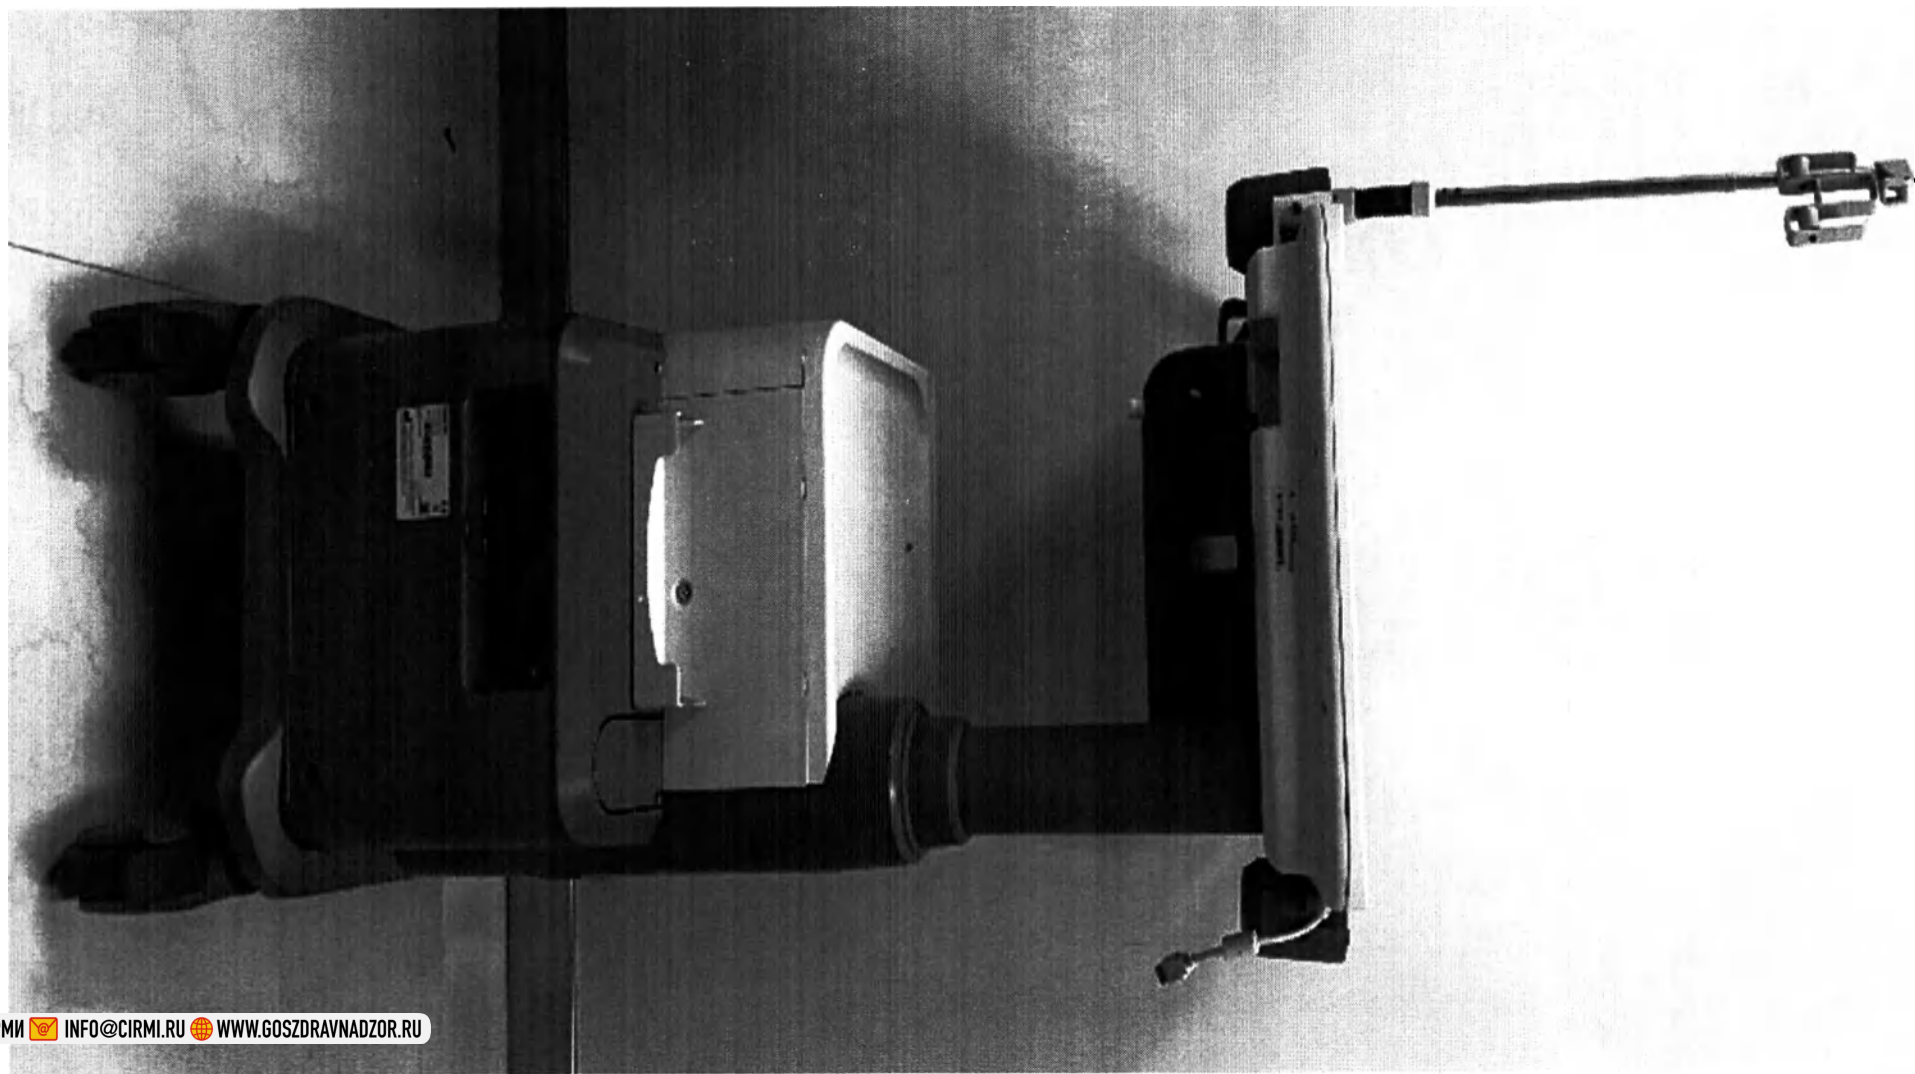


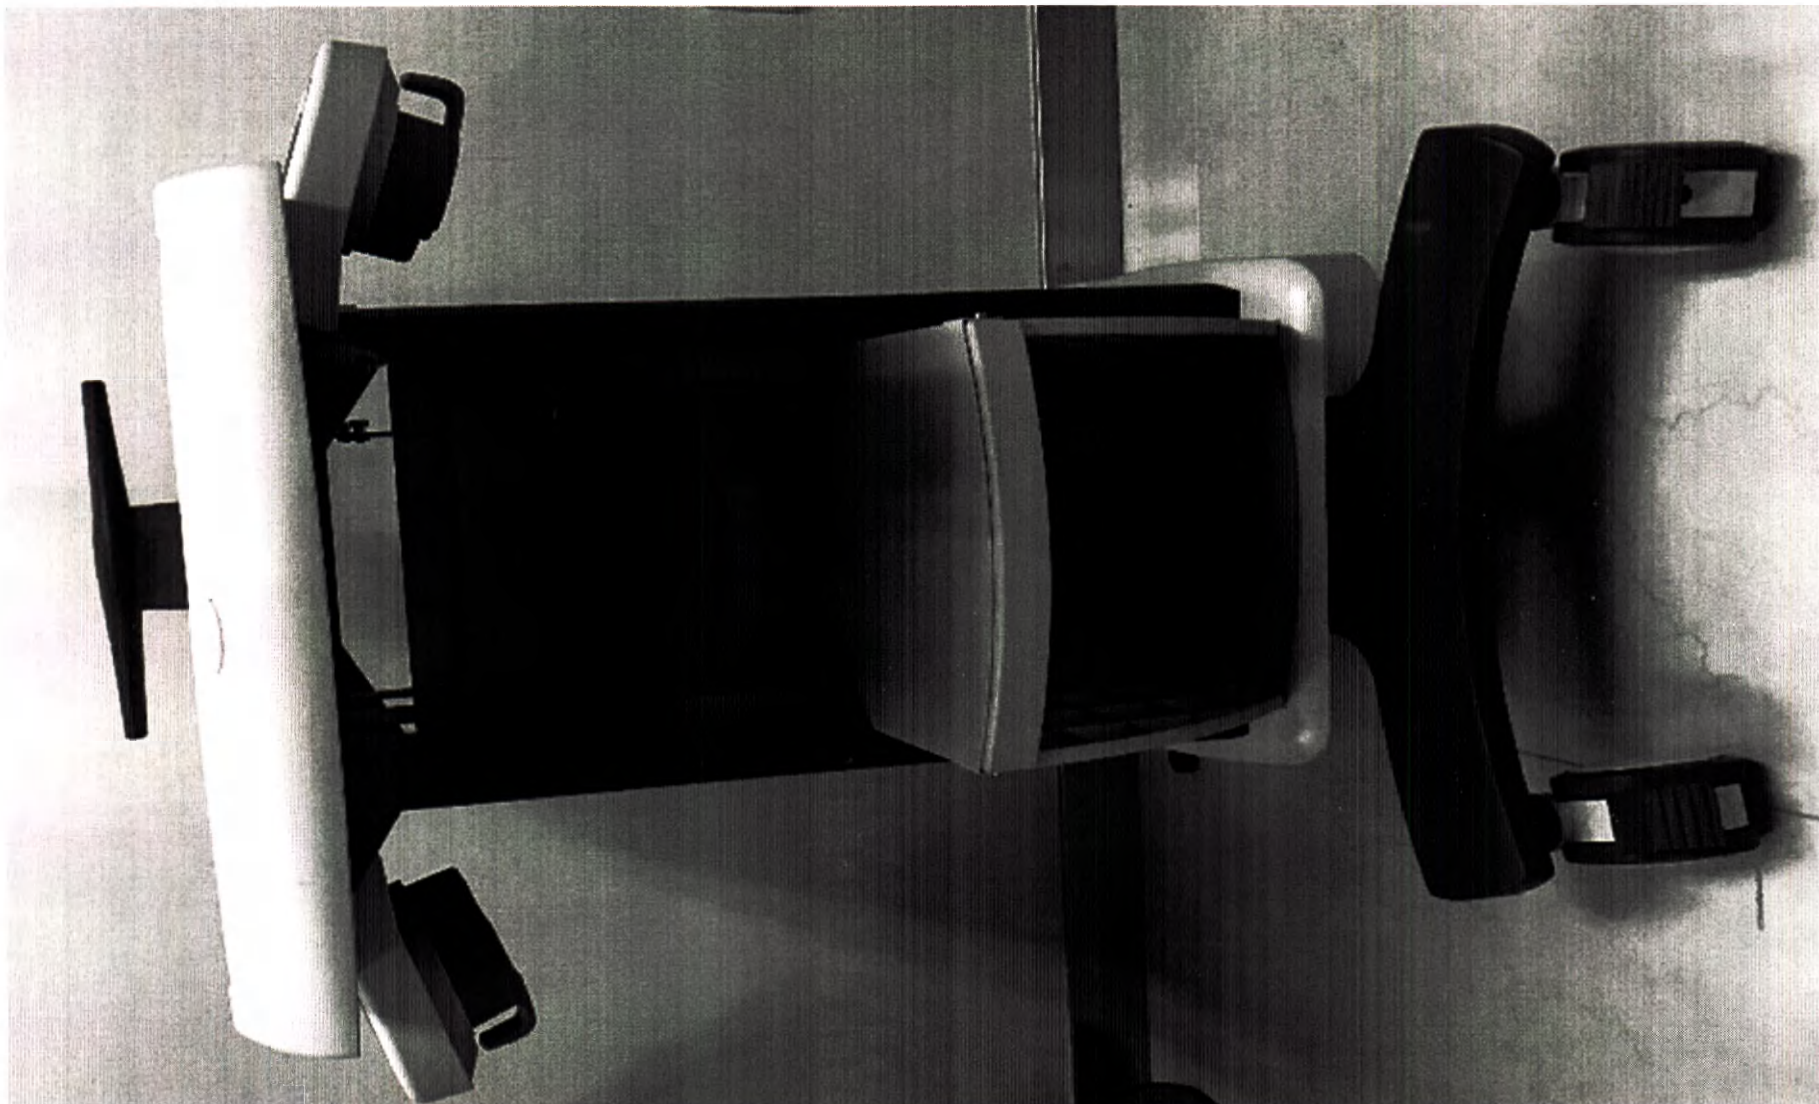

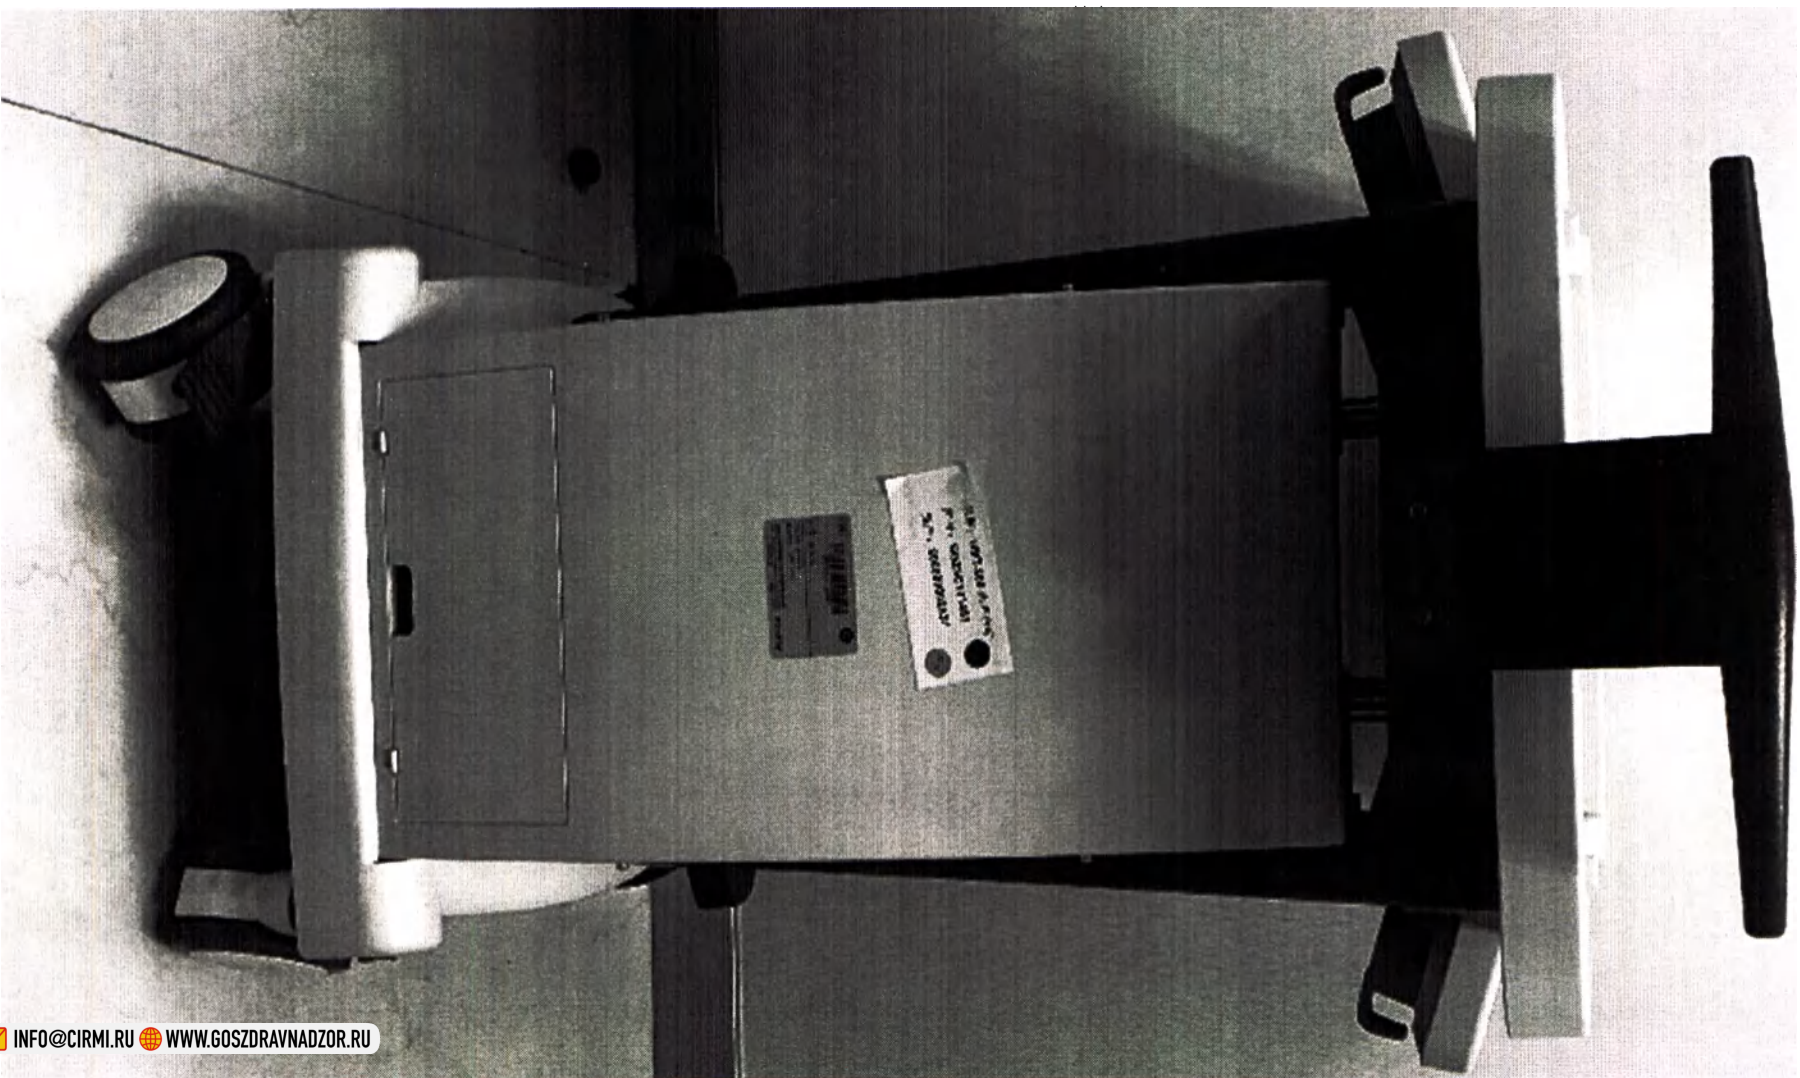

Принадлежности:


1. Ножной переключатель, 2 клавиши

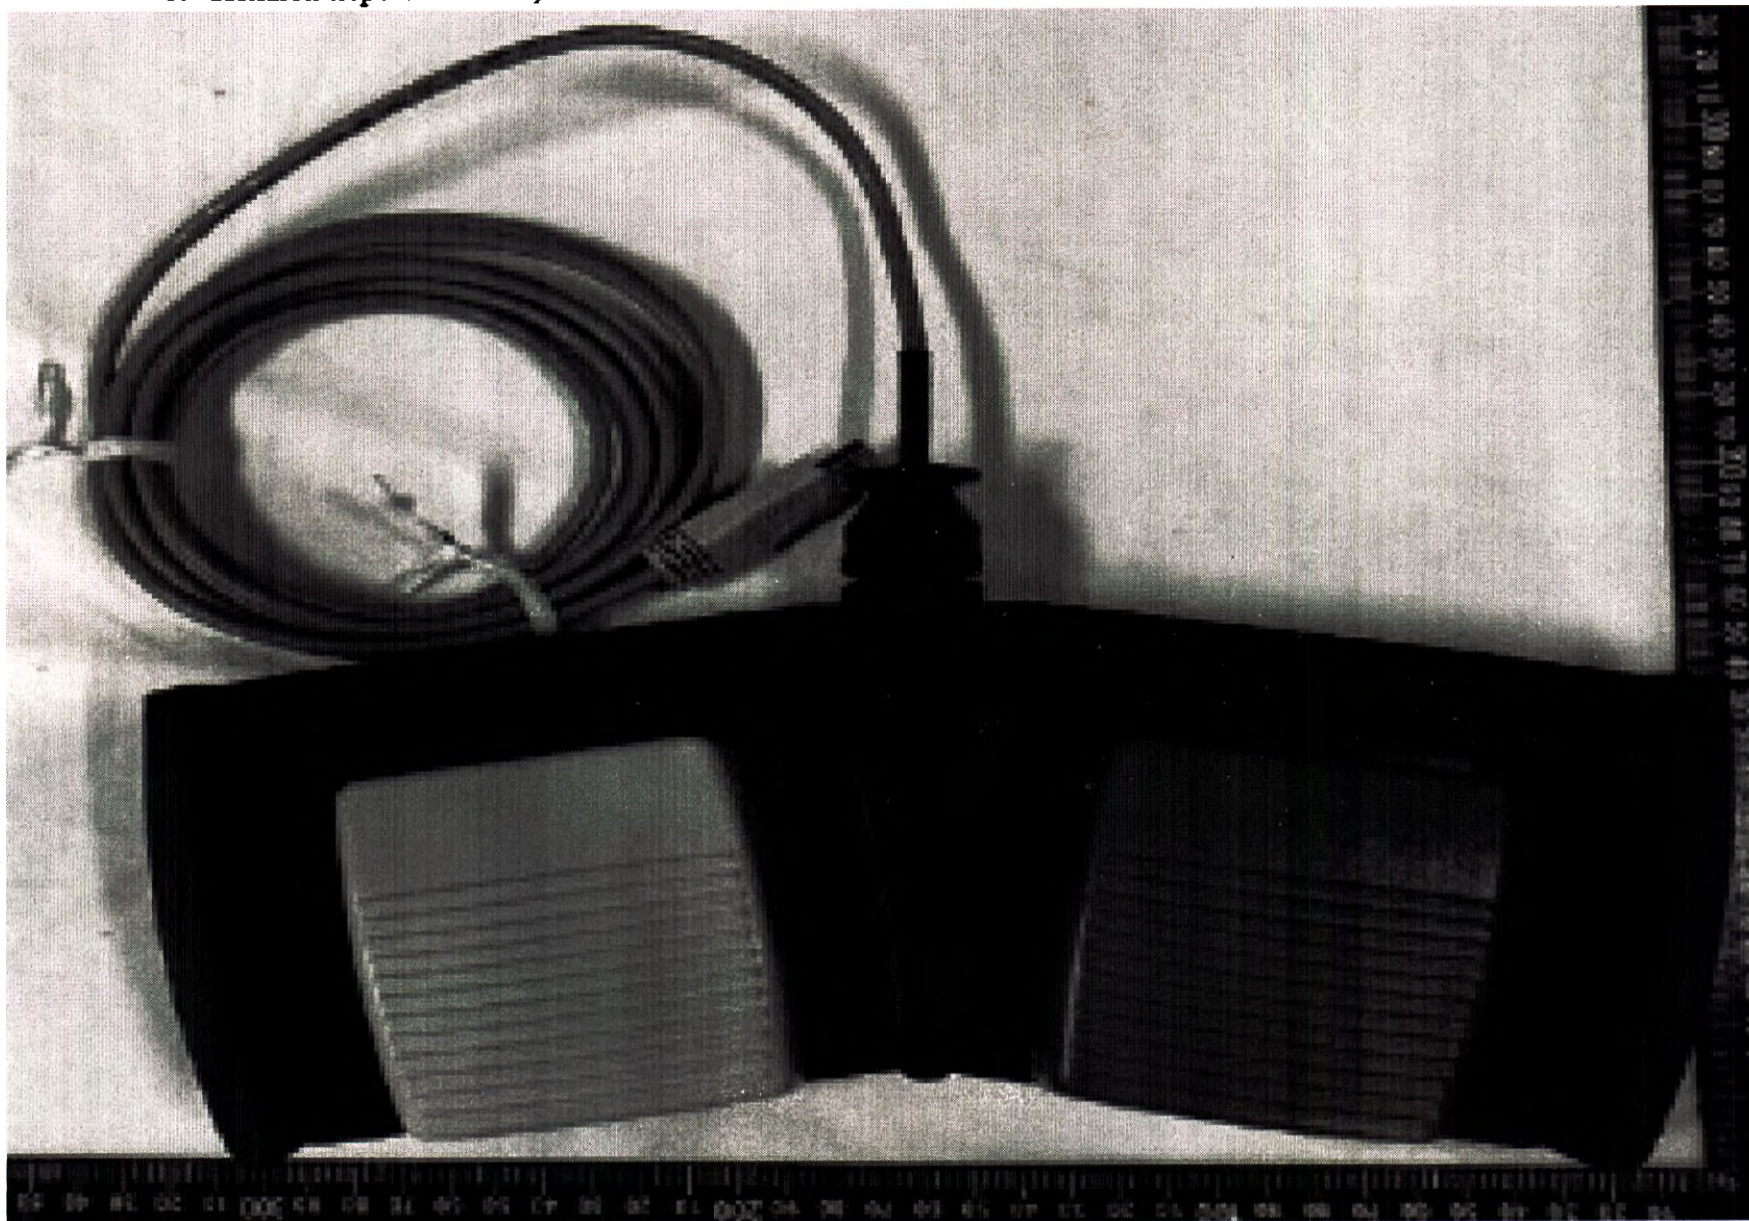


2.Ножной переключатель, 3 клавиши




II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М58, в составе:
1. Основной блок М58

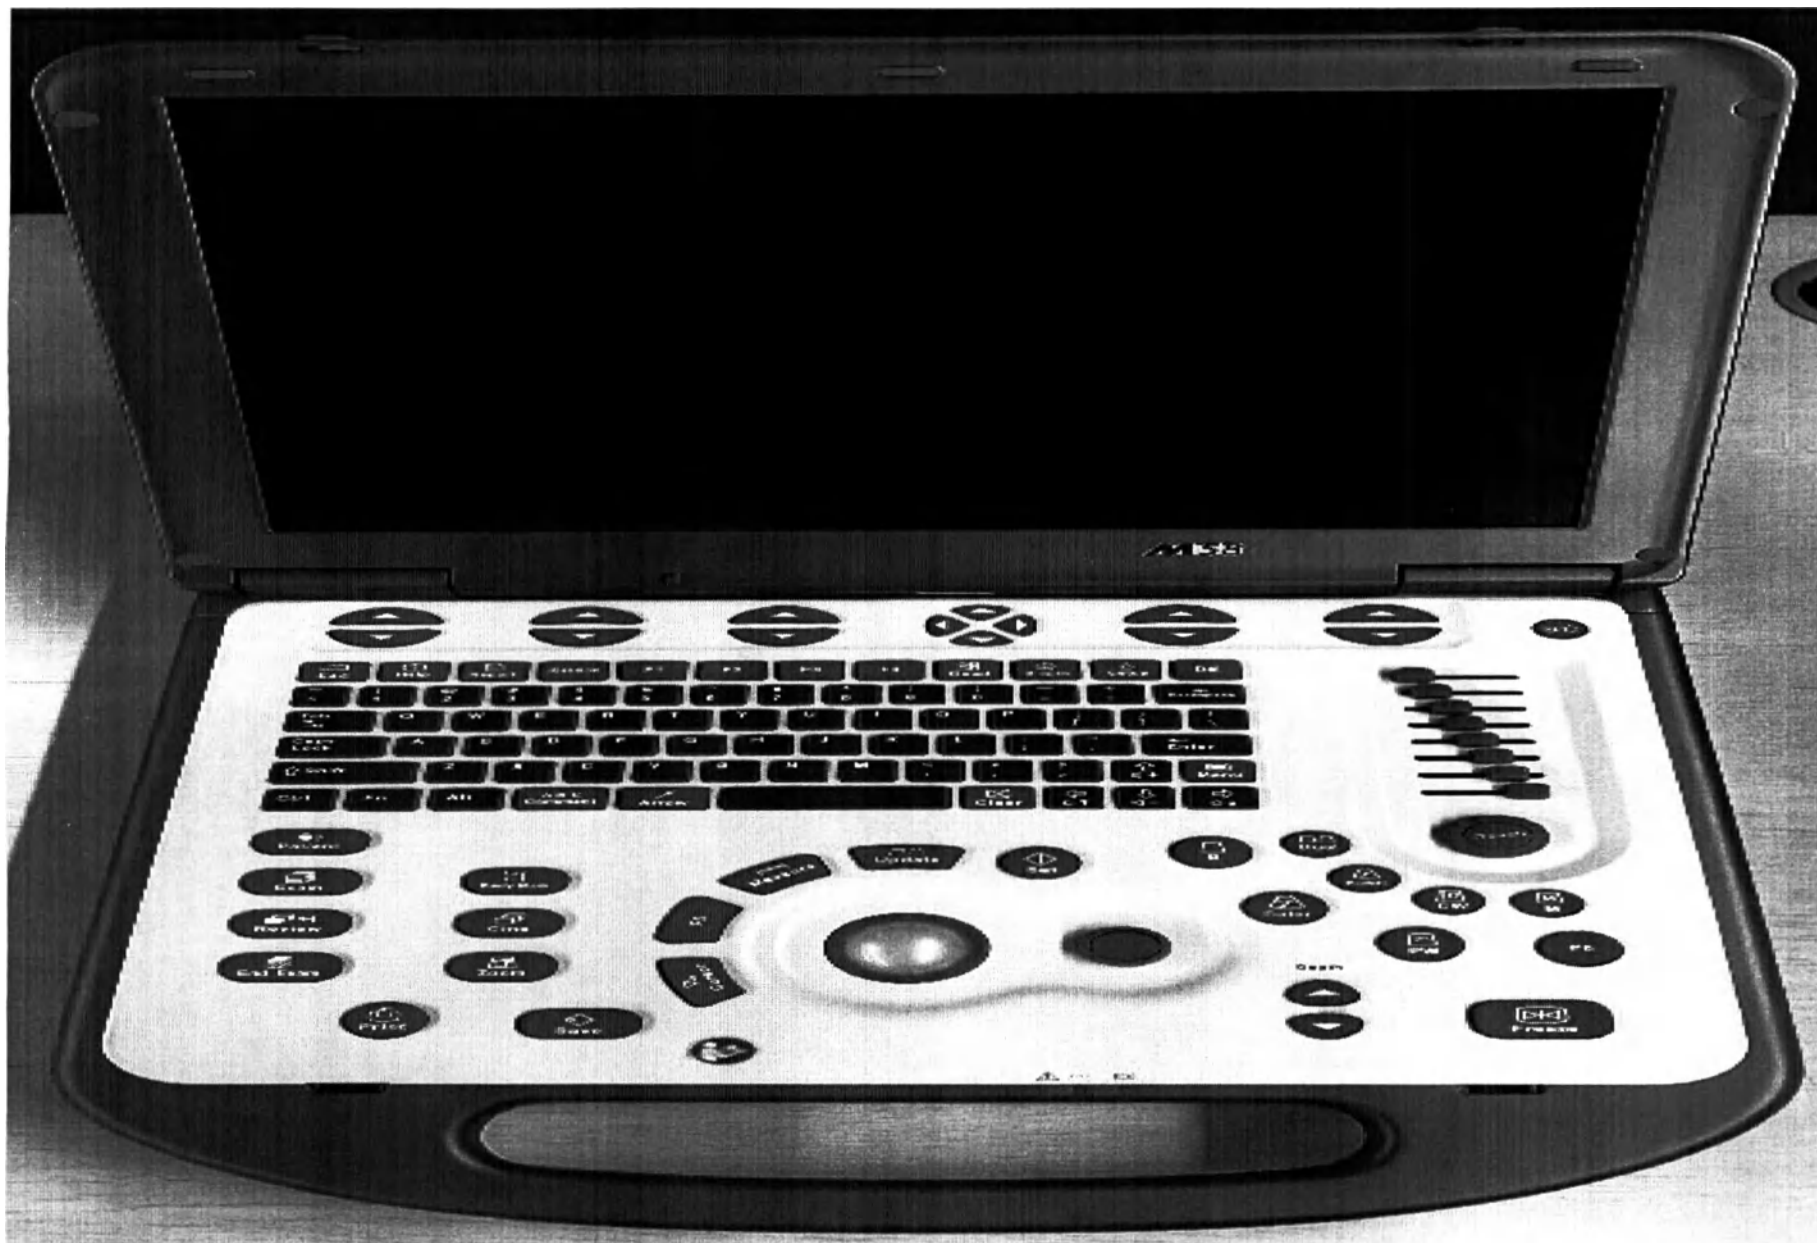


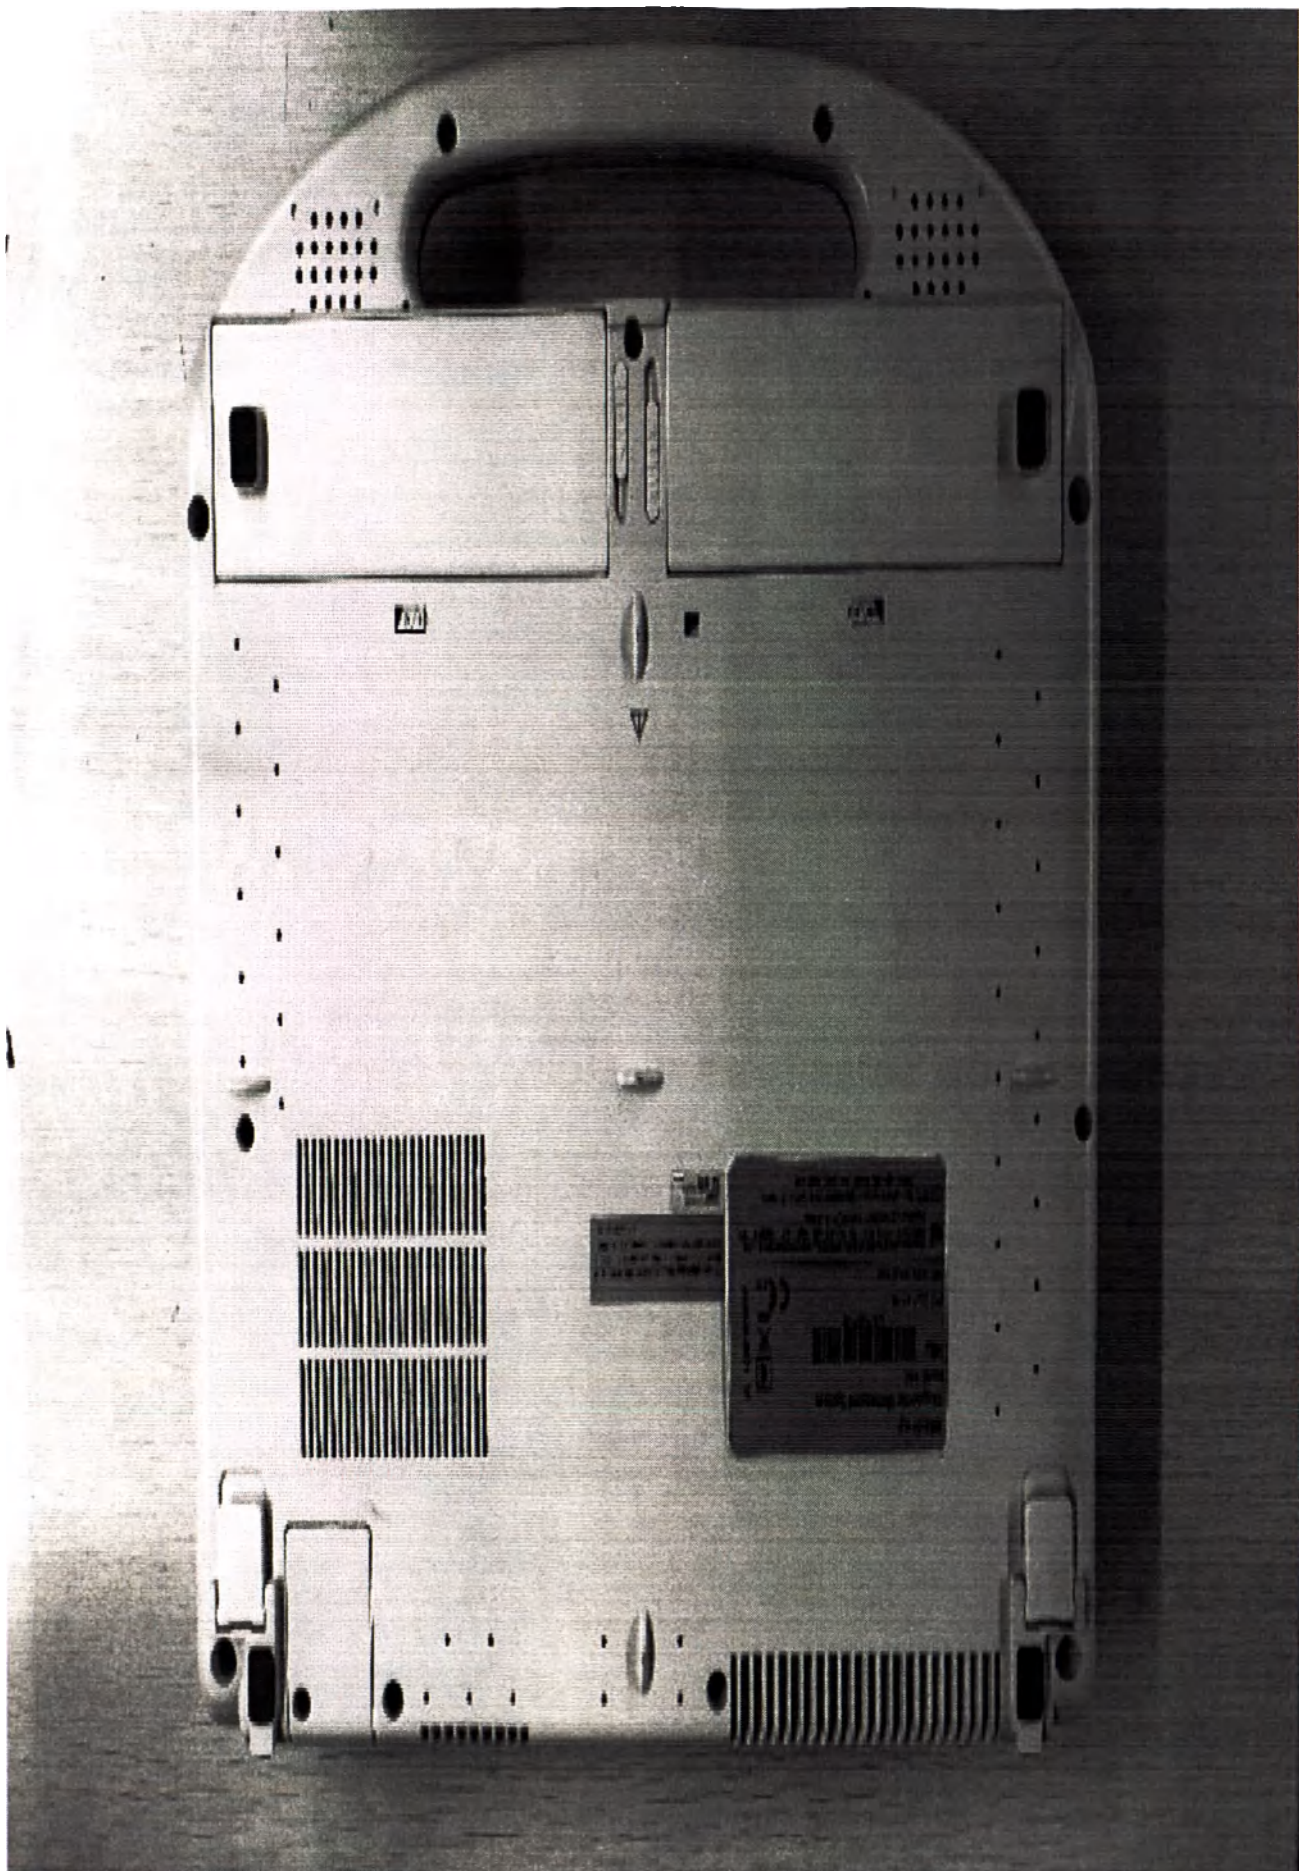


2. Руководство по эксплуатации

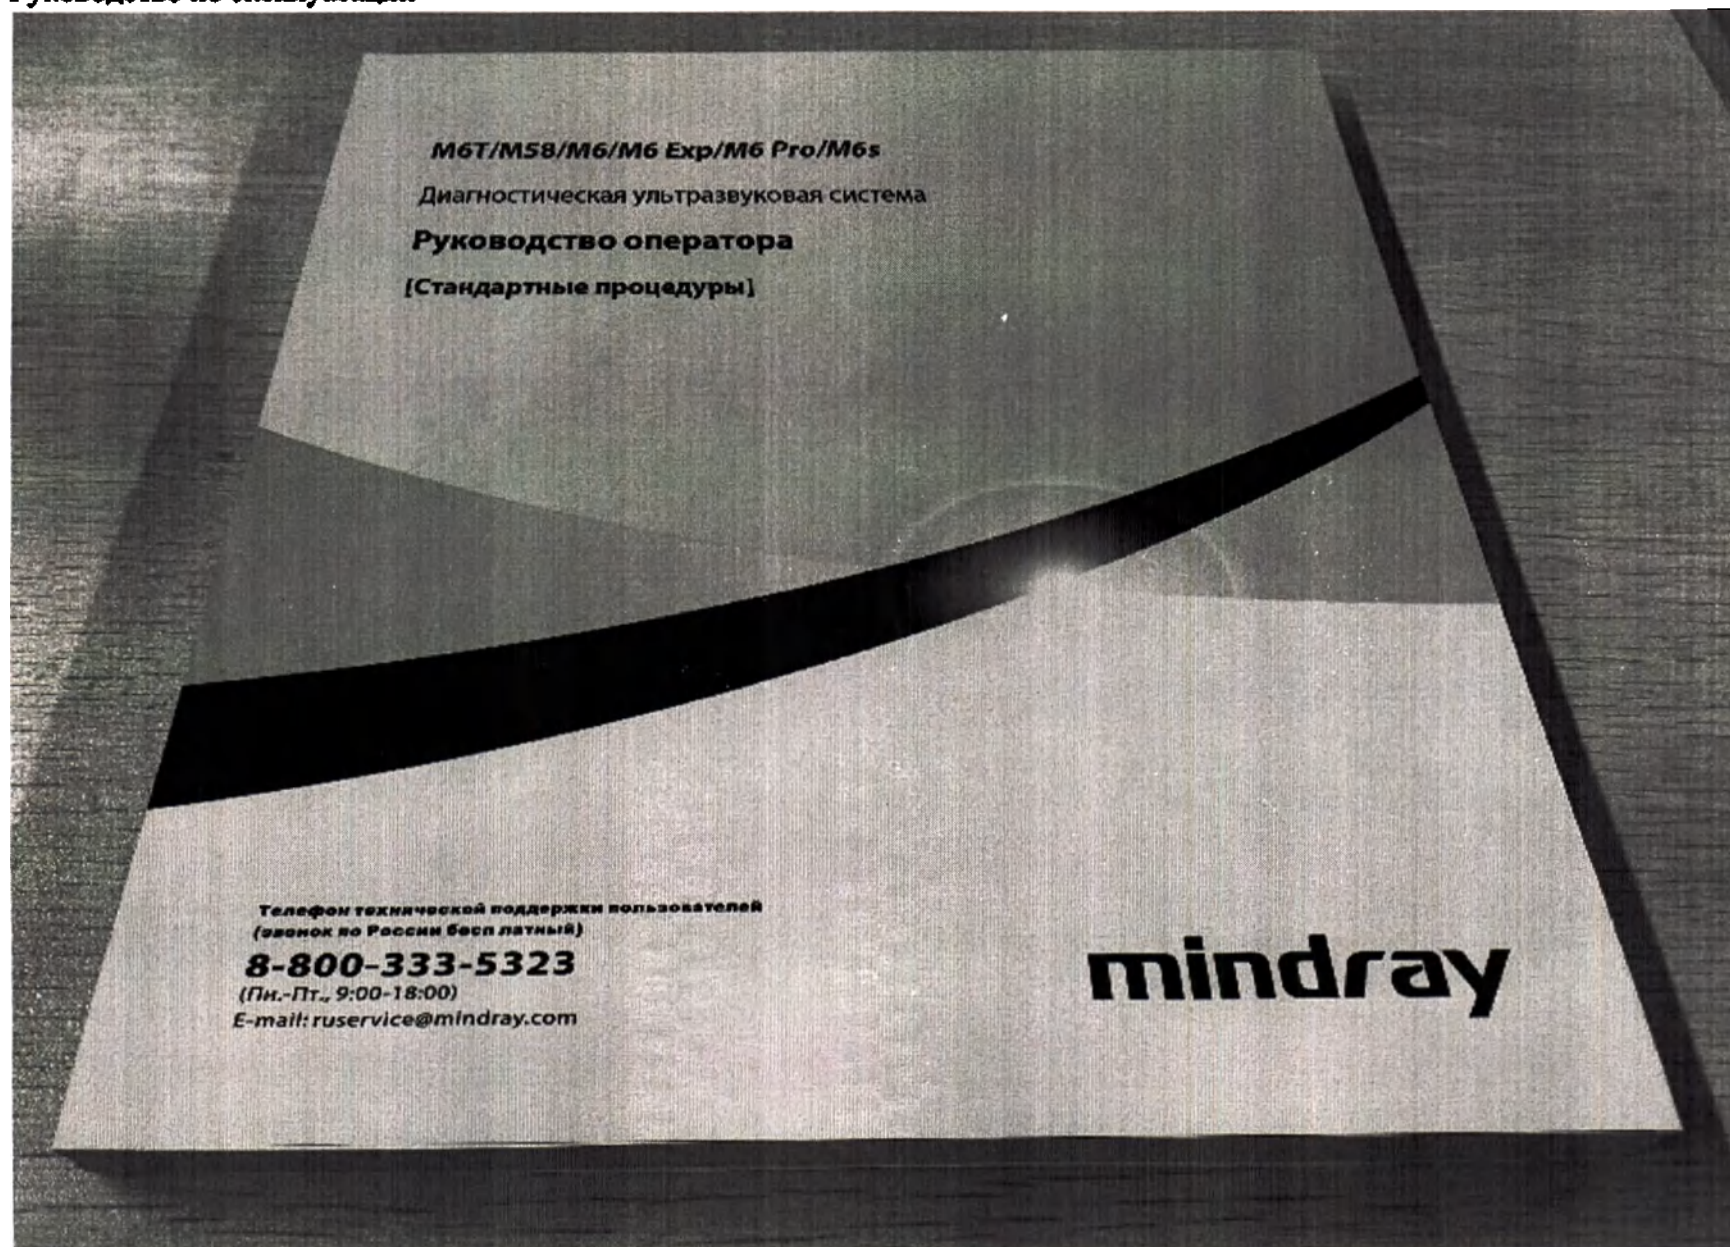

4. Кабель питания

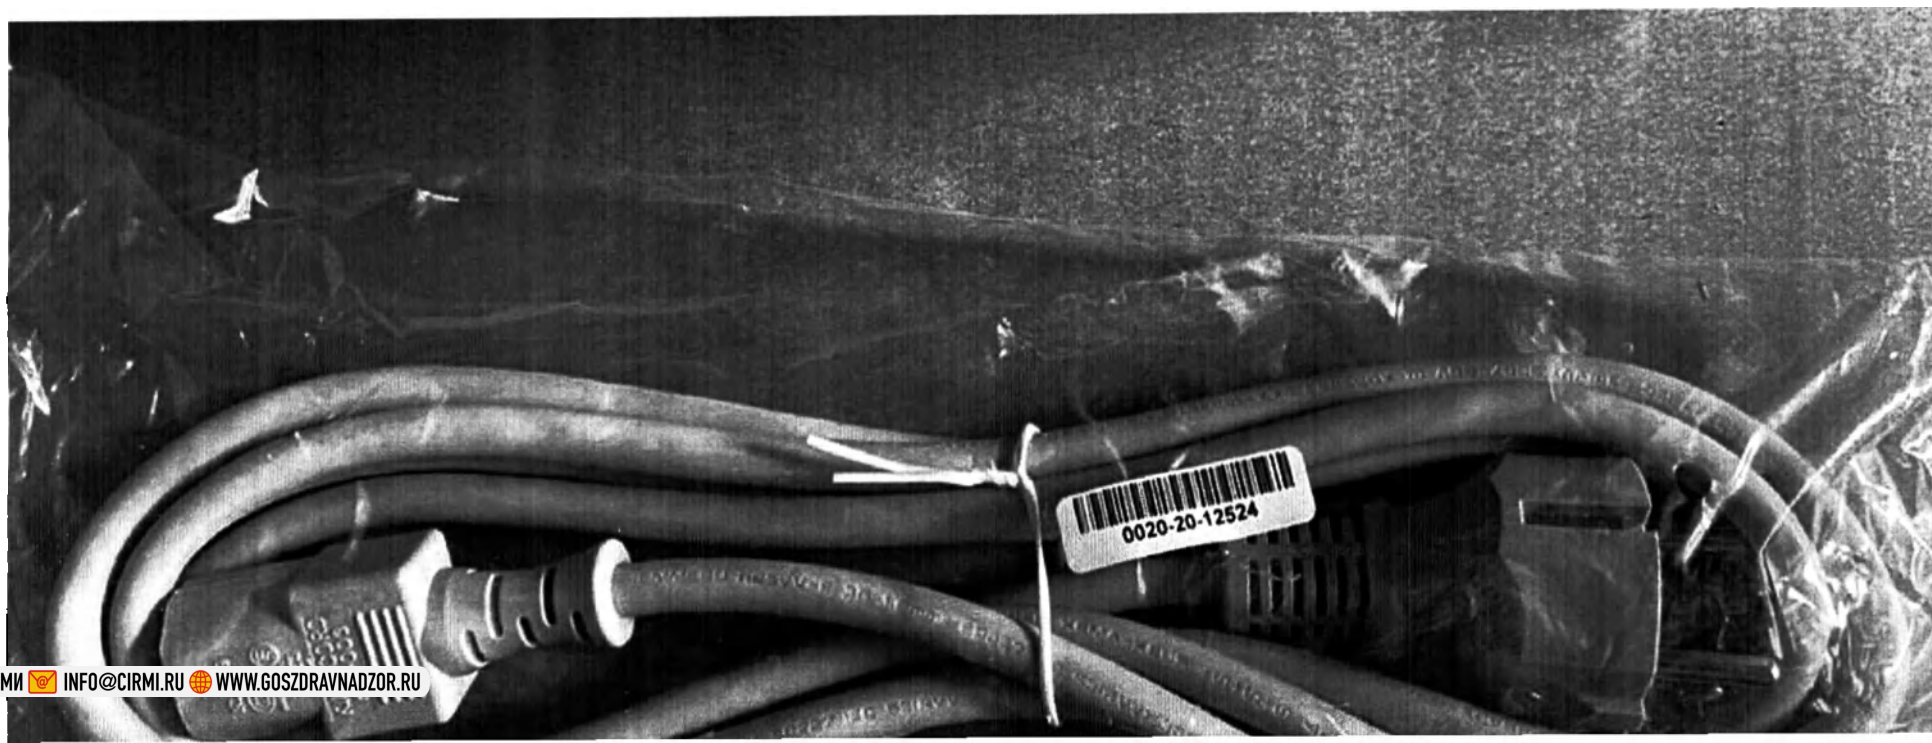

5. Накладка на панель управления(русифицированная)

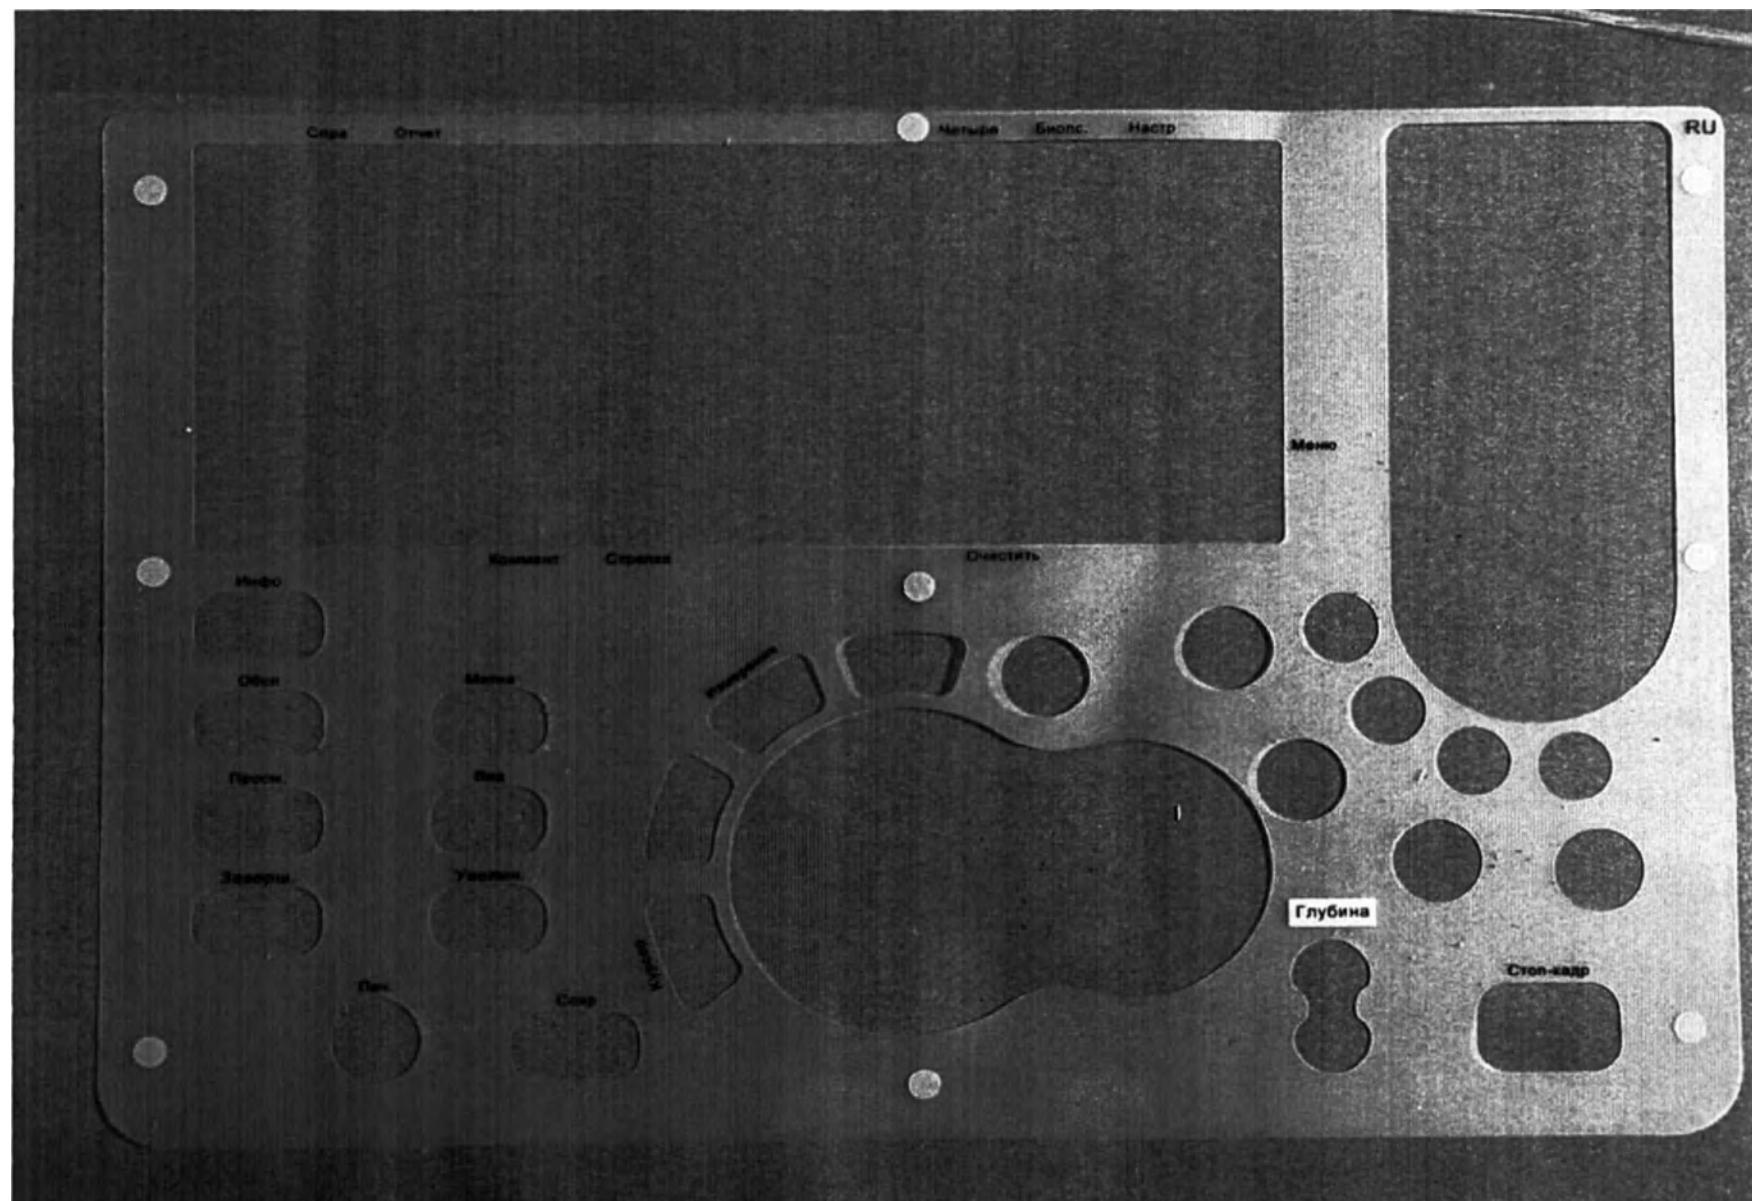


6. Адаптер питания








8. Разветвитель для датчиков

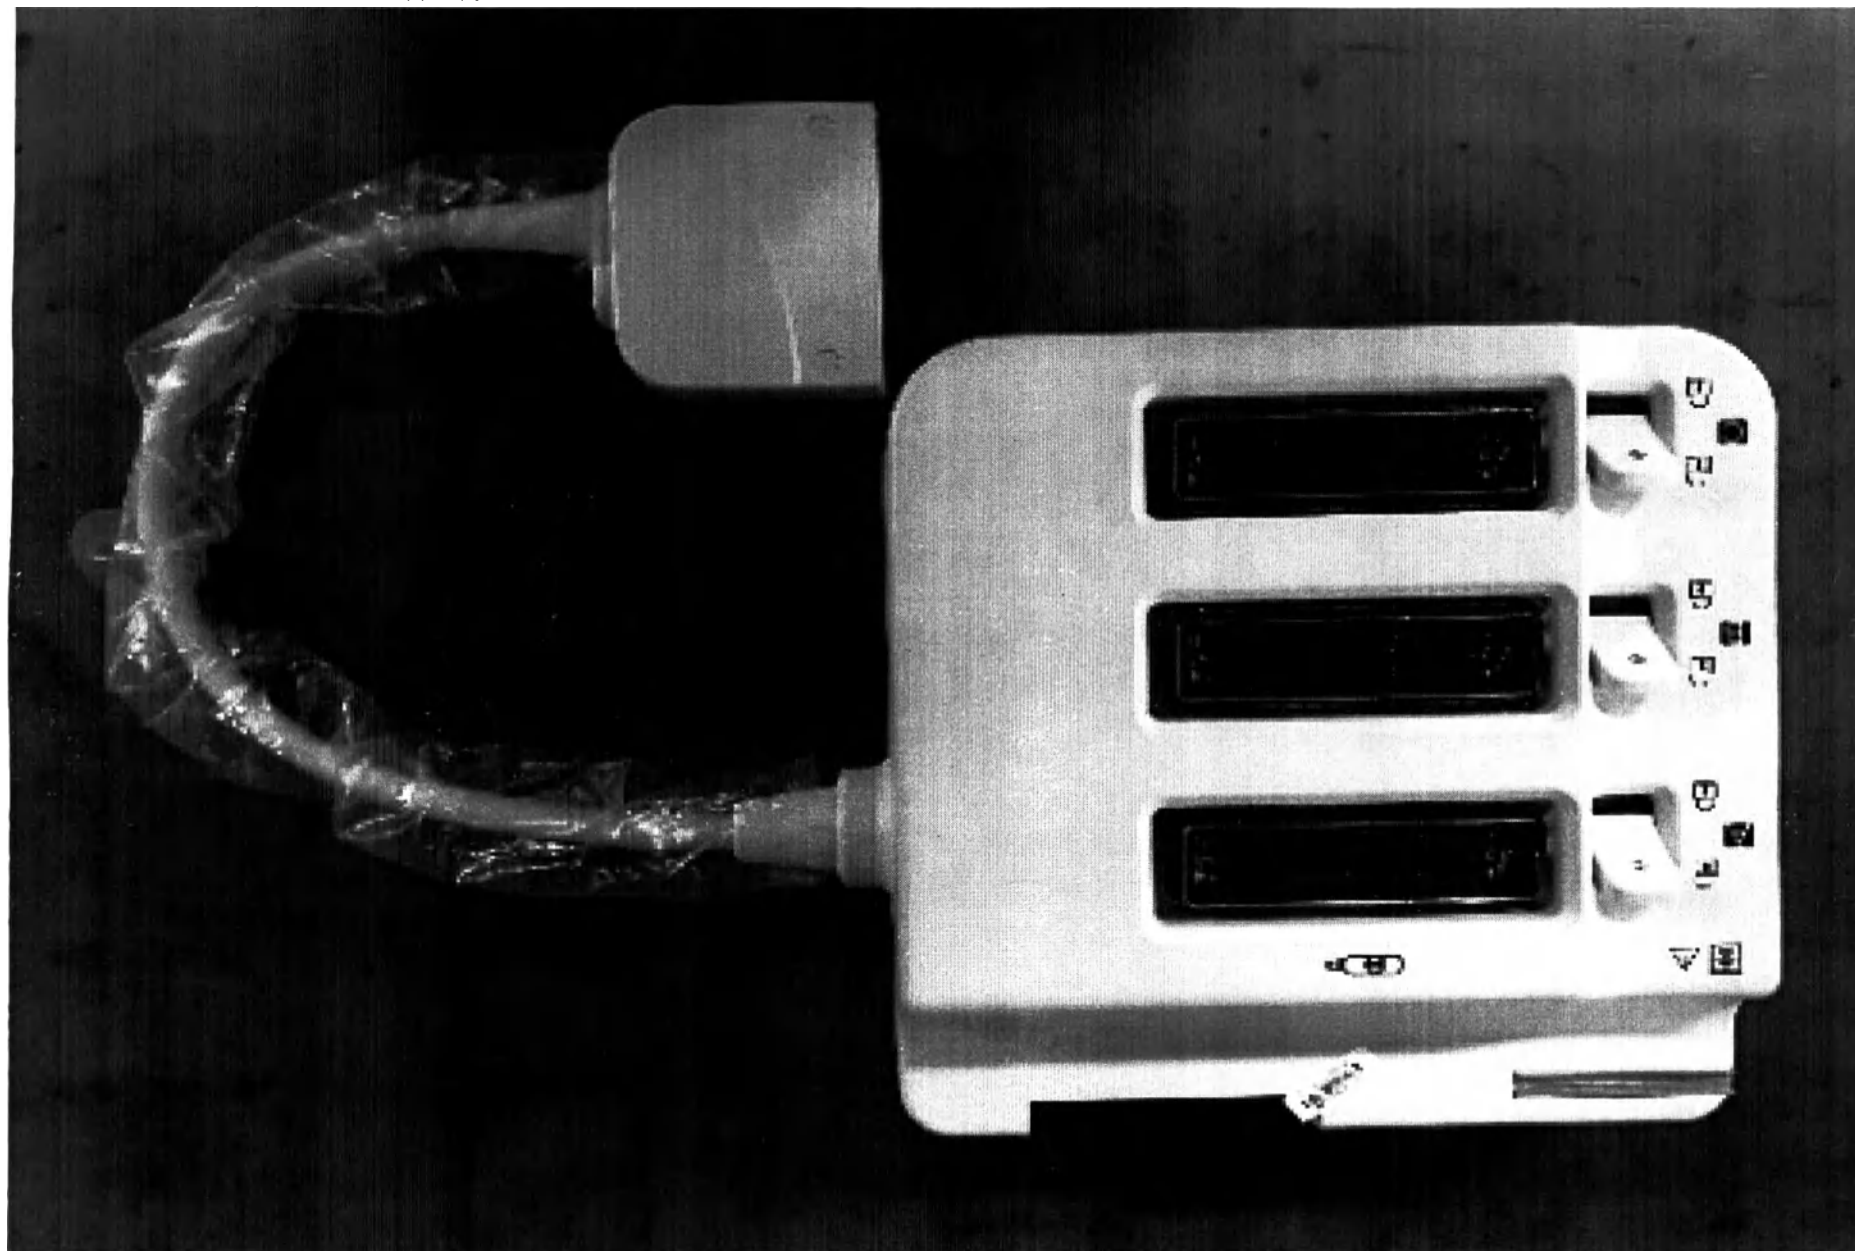


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

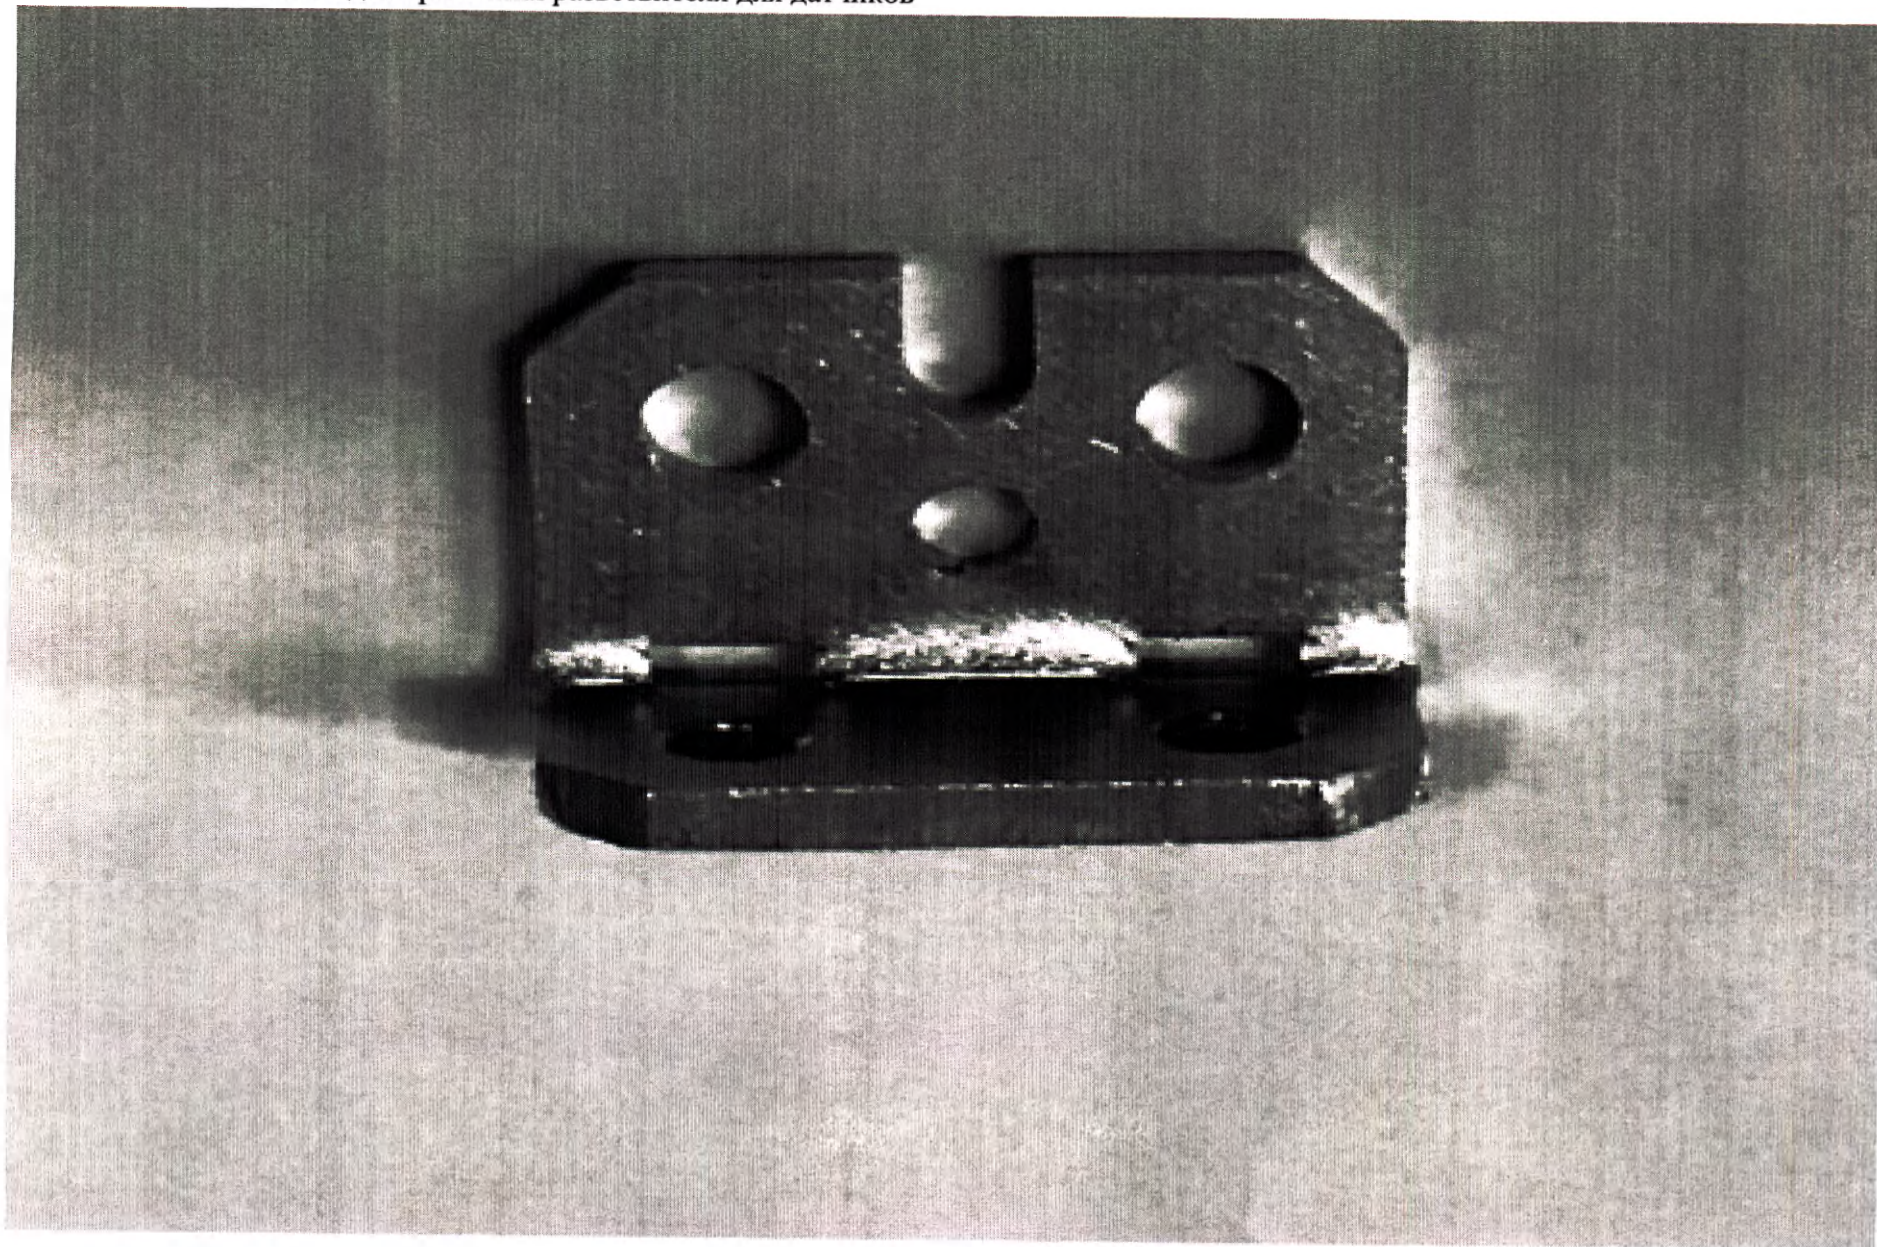


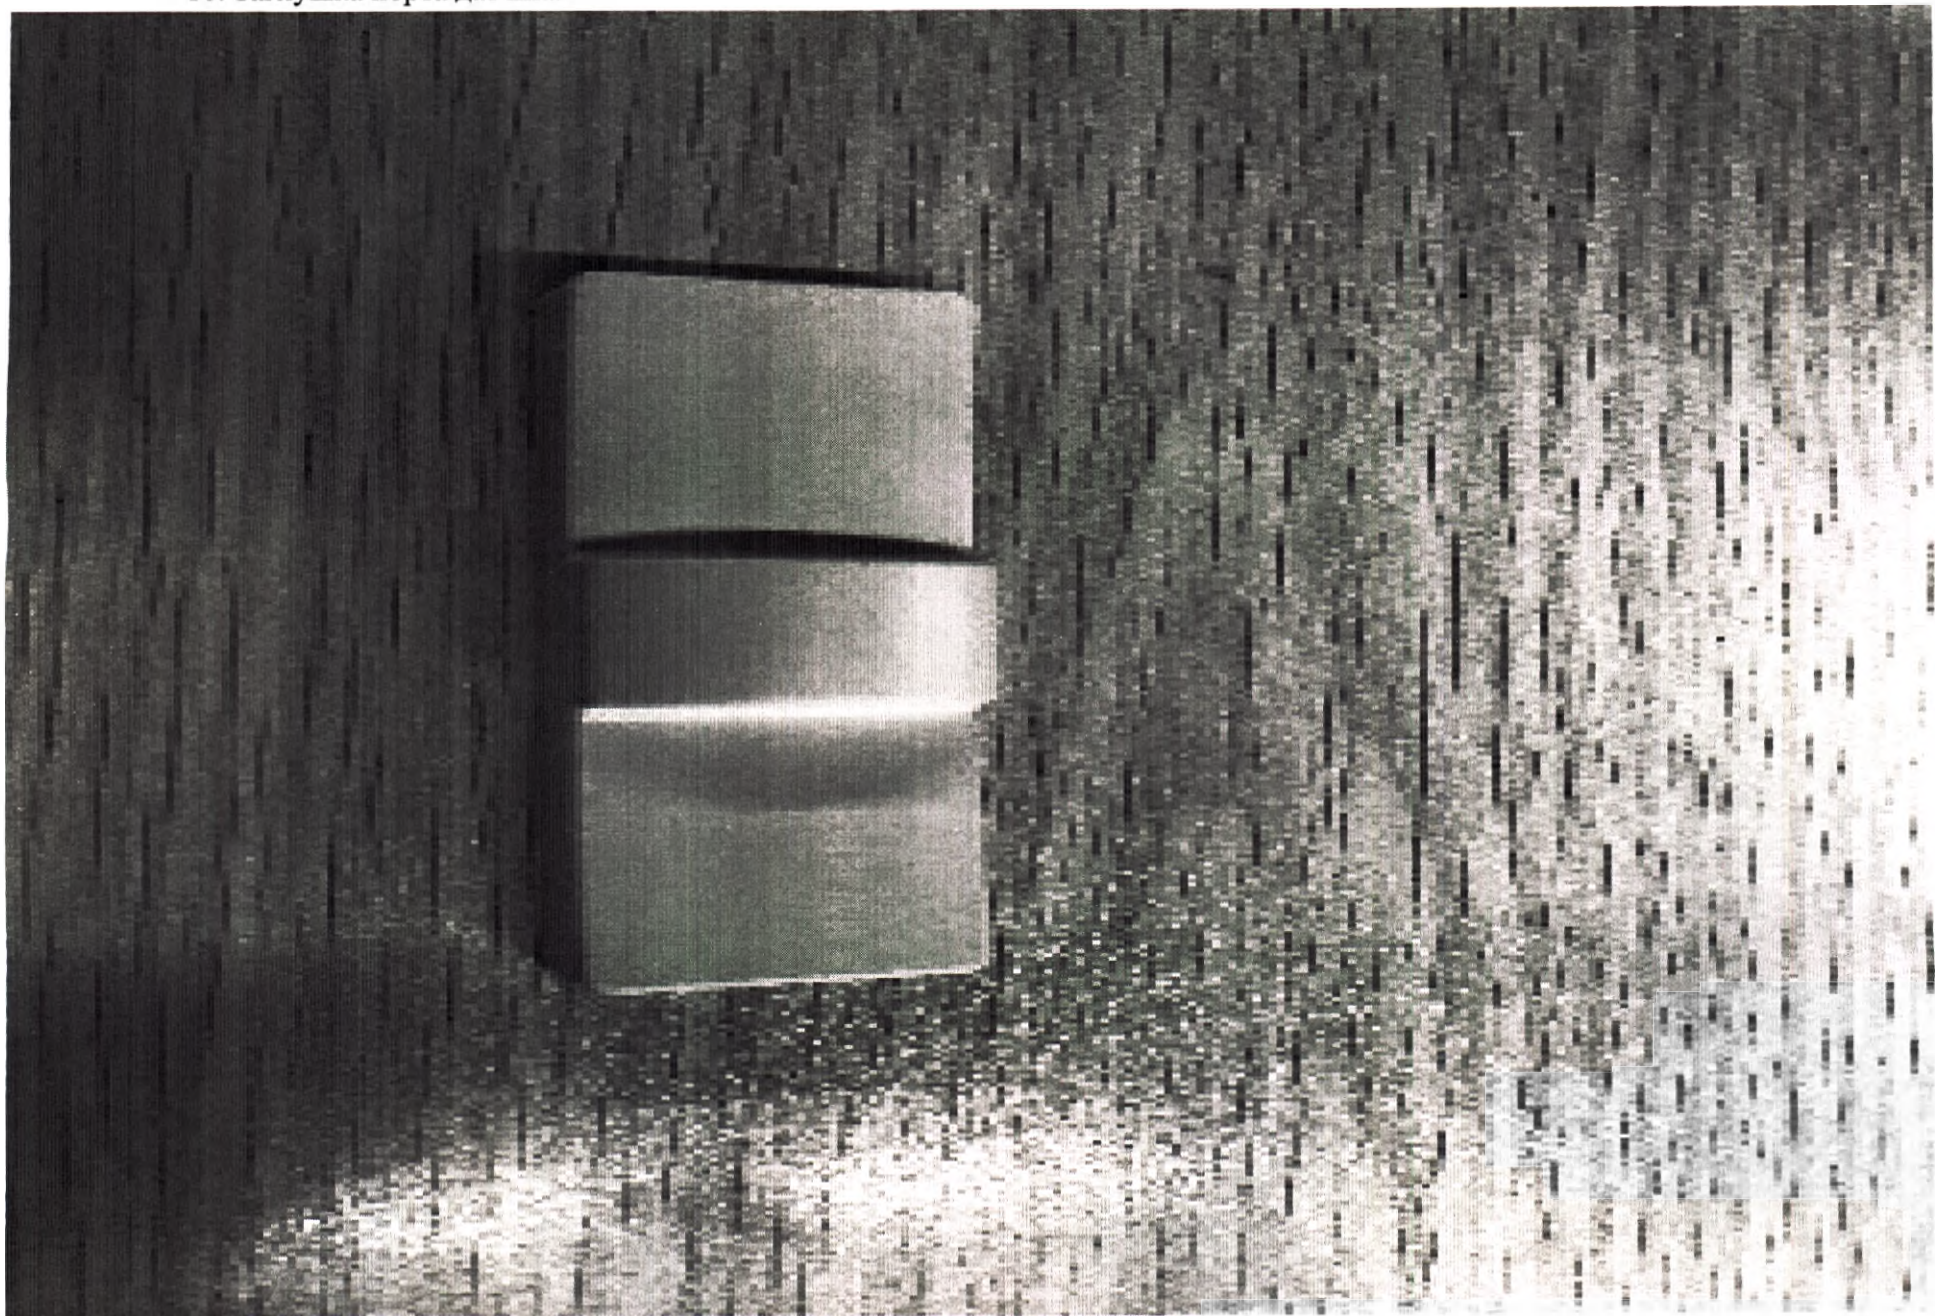


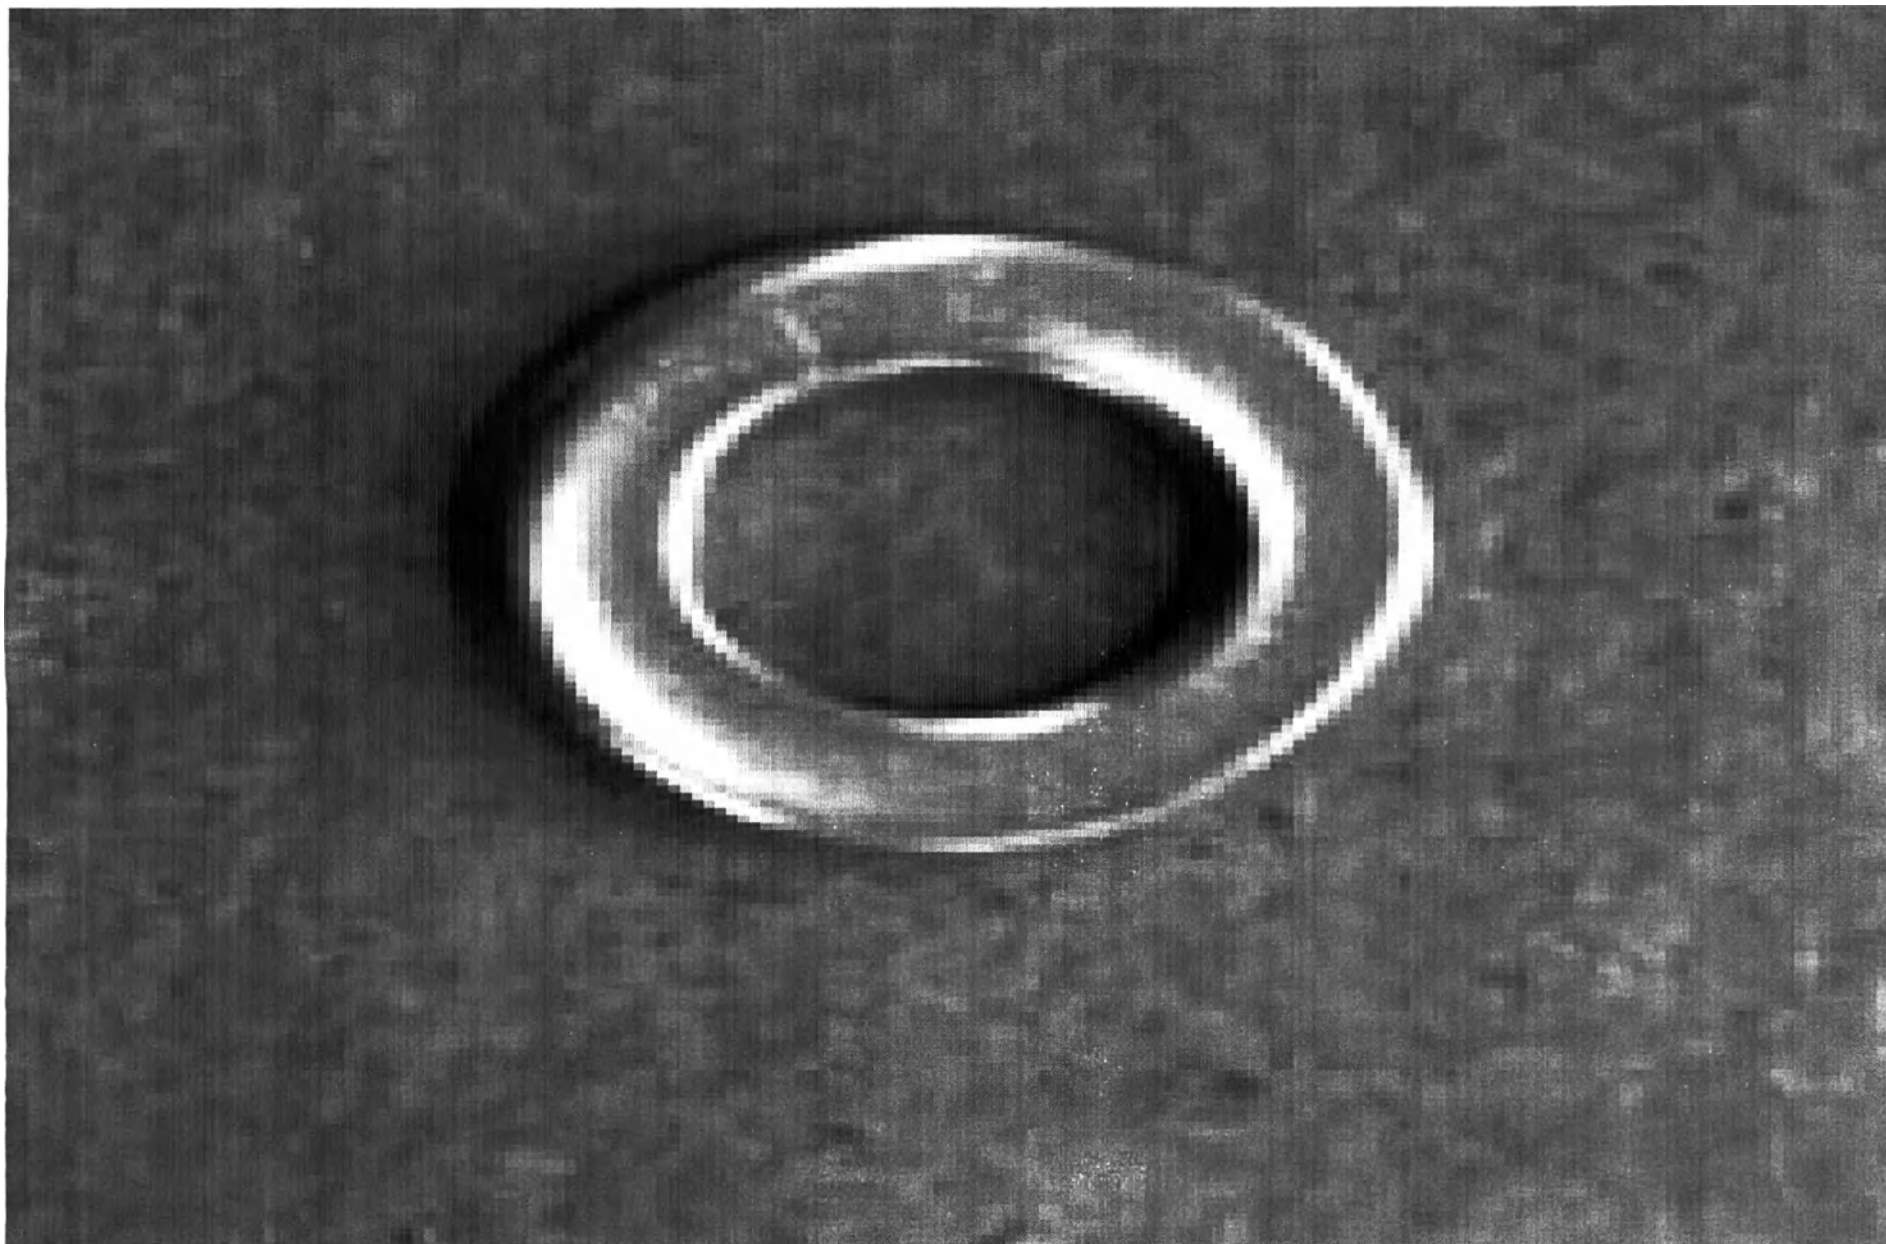

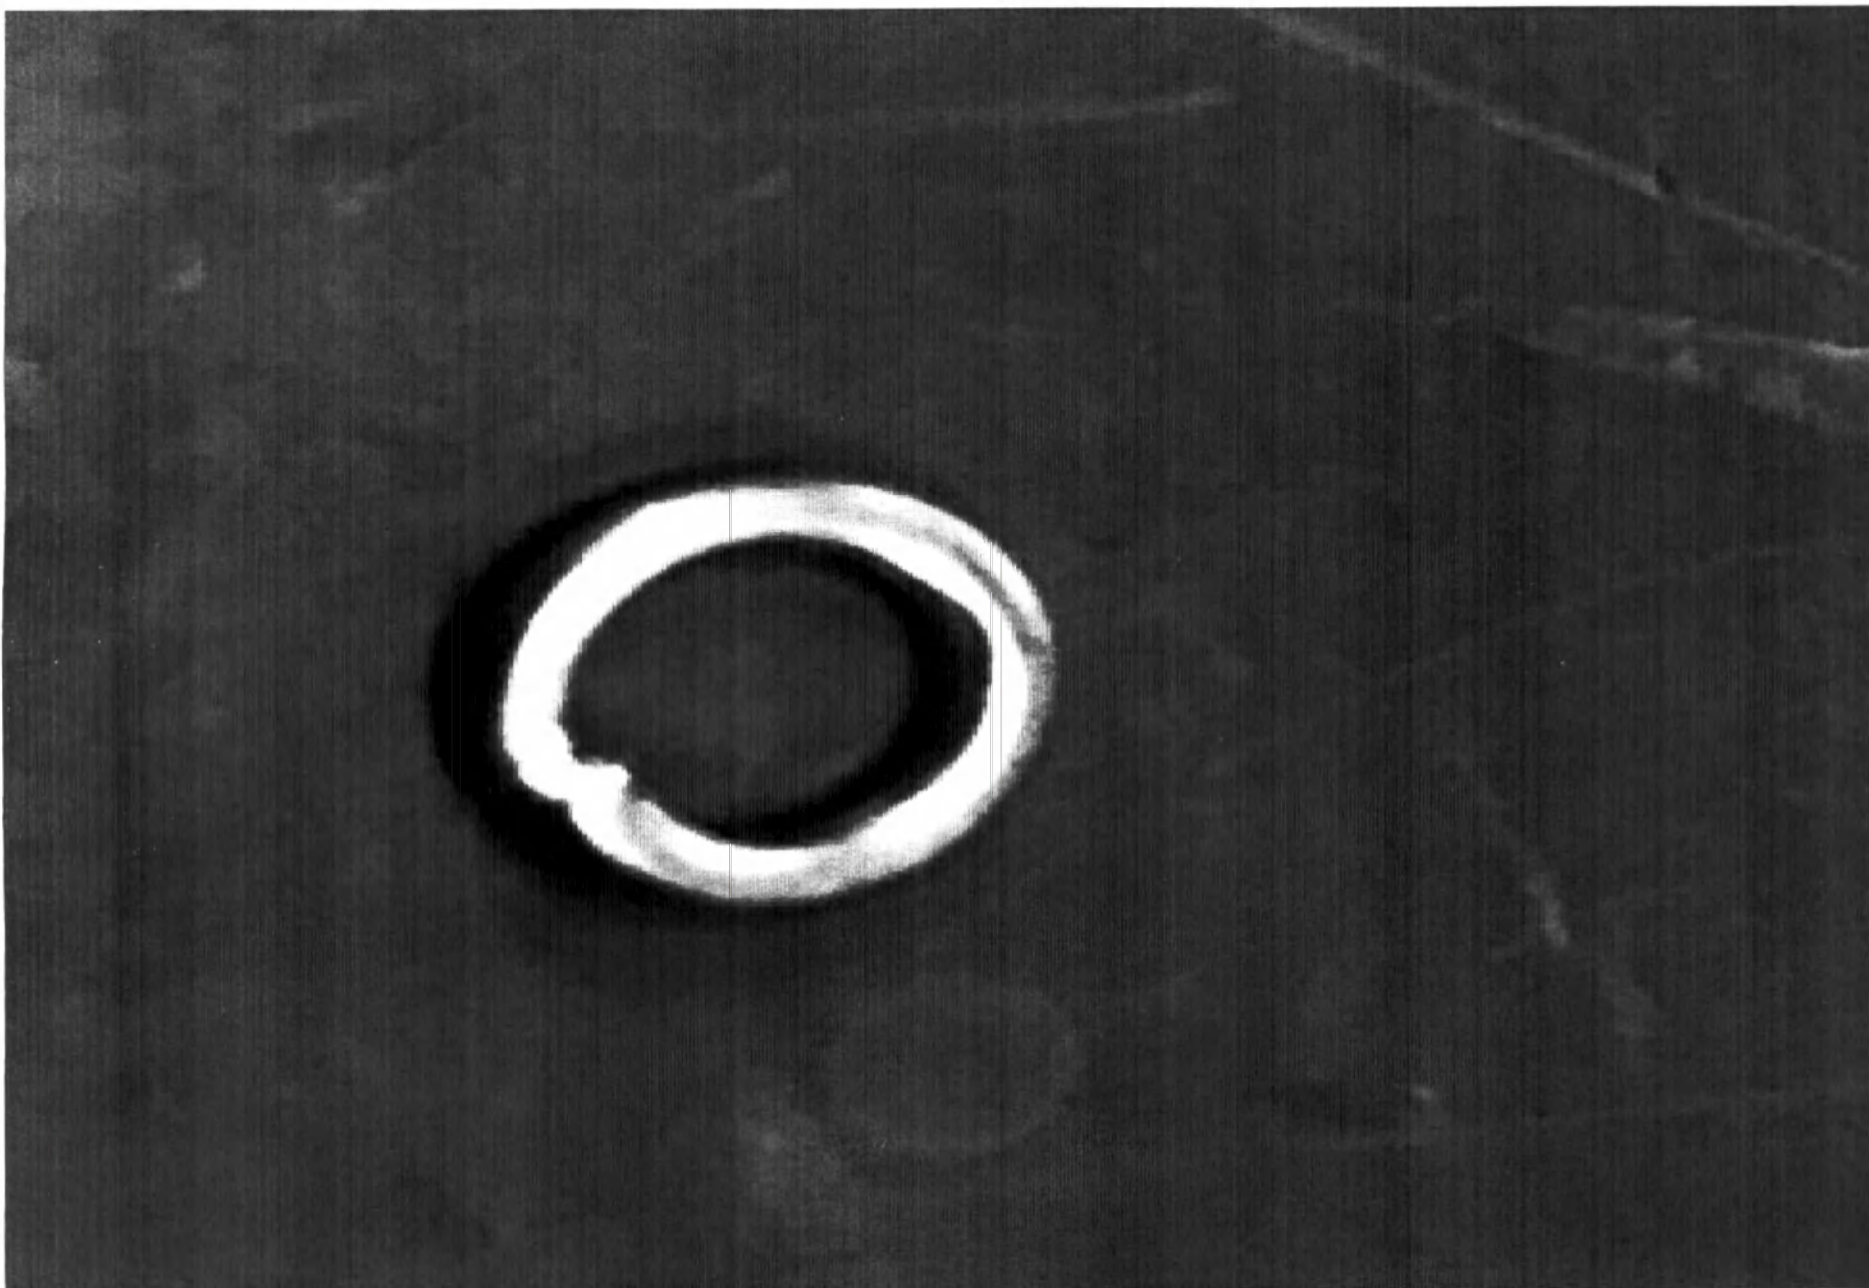

13. Винт с головкой под шестигранный ключ

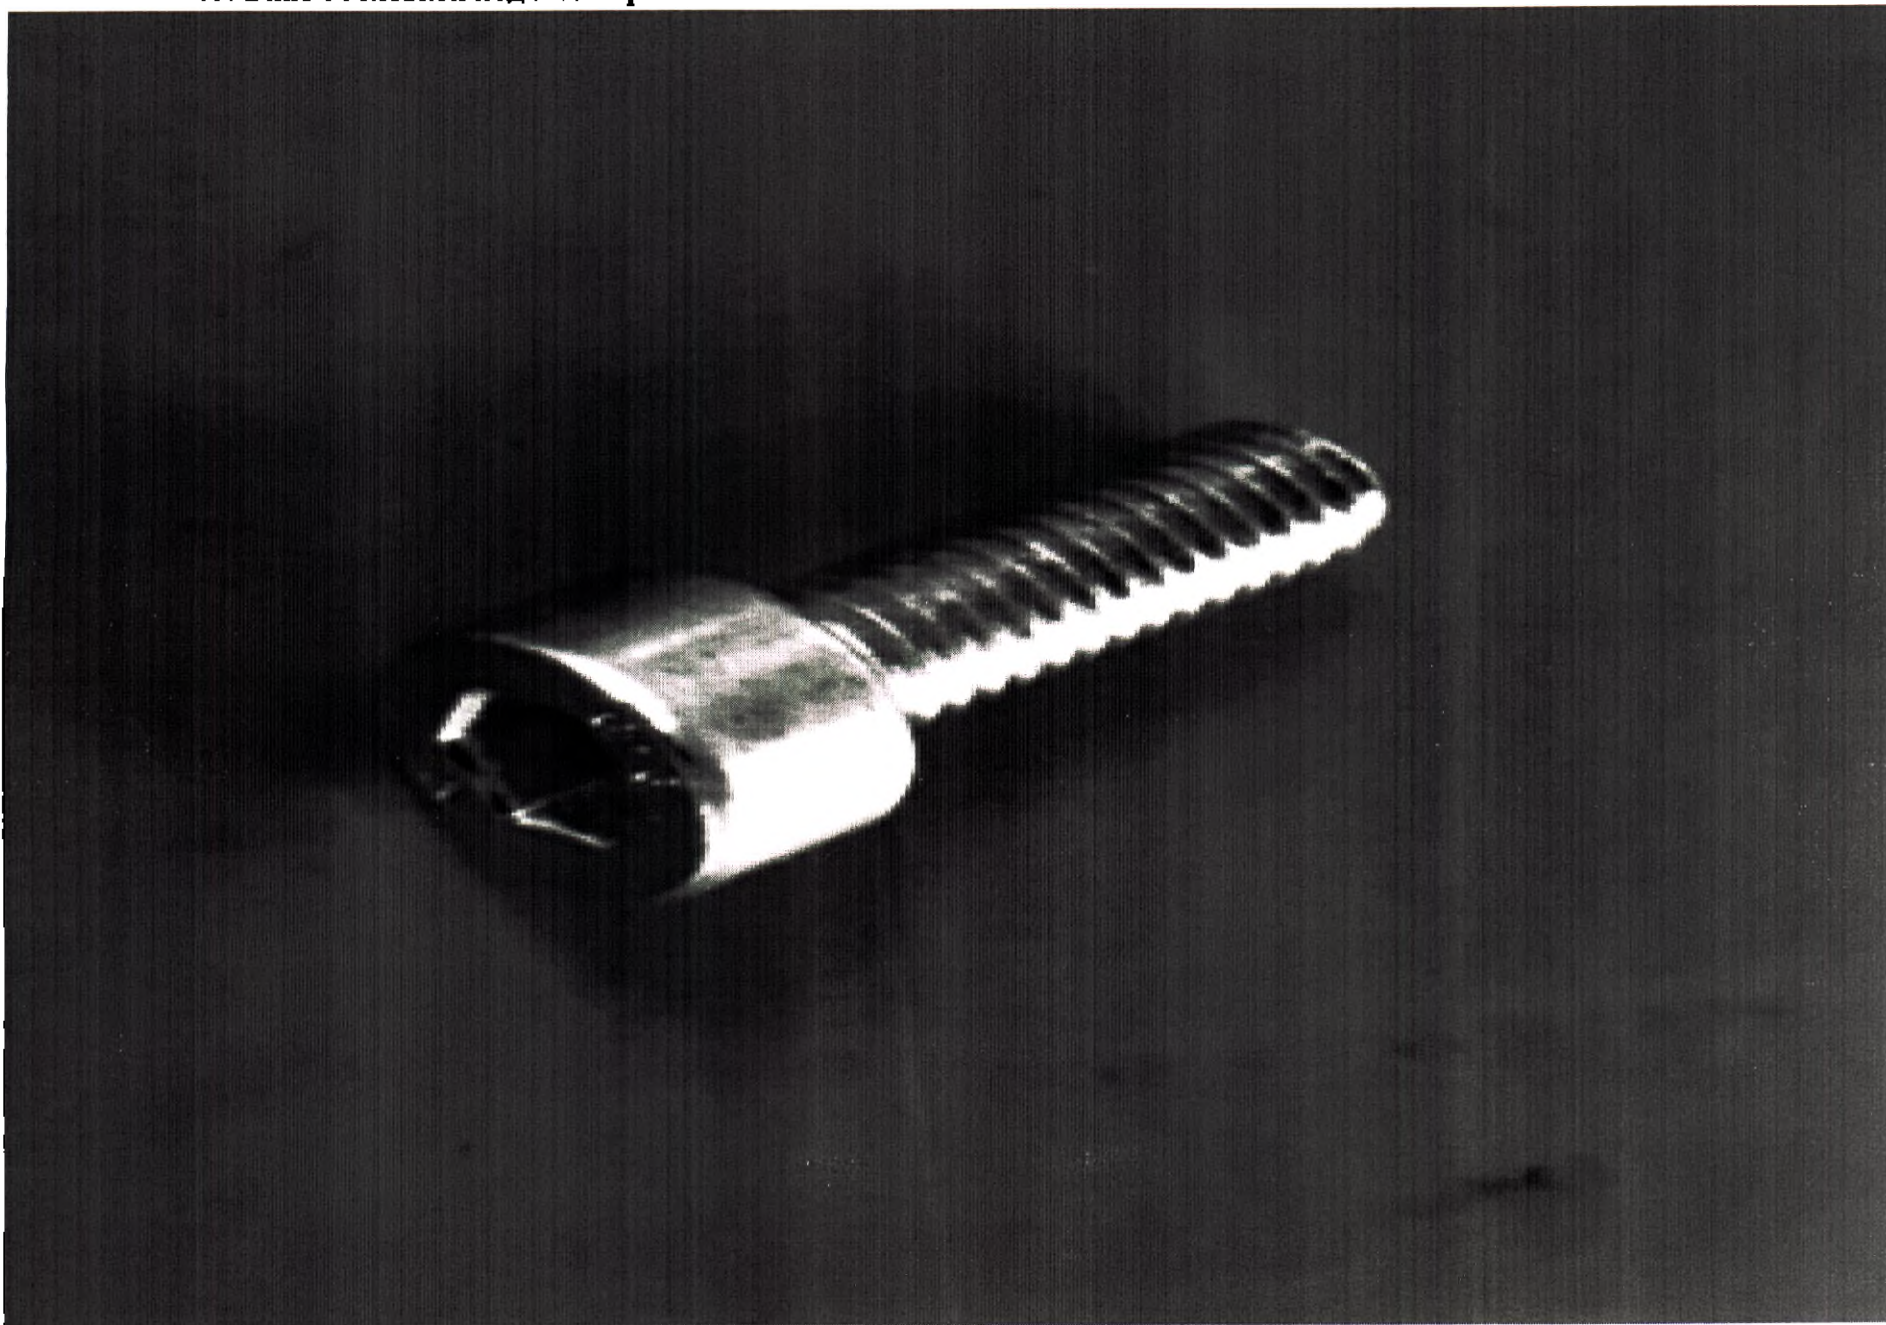


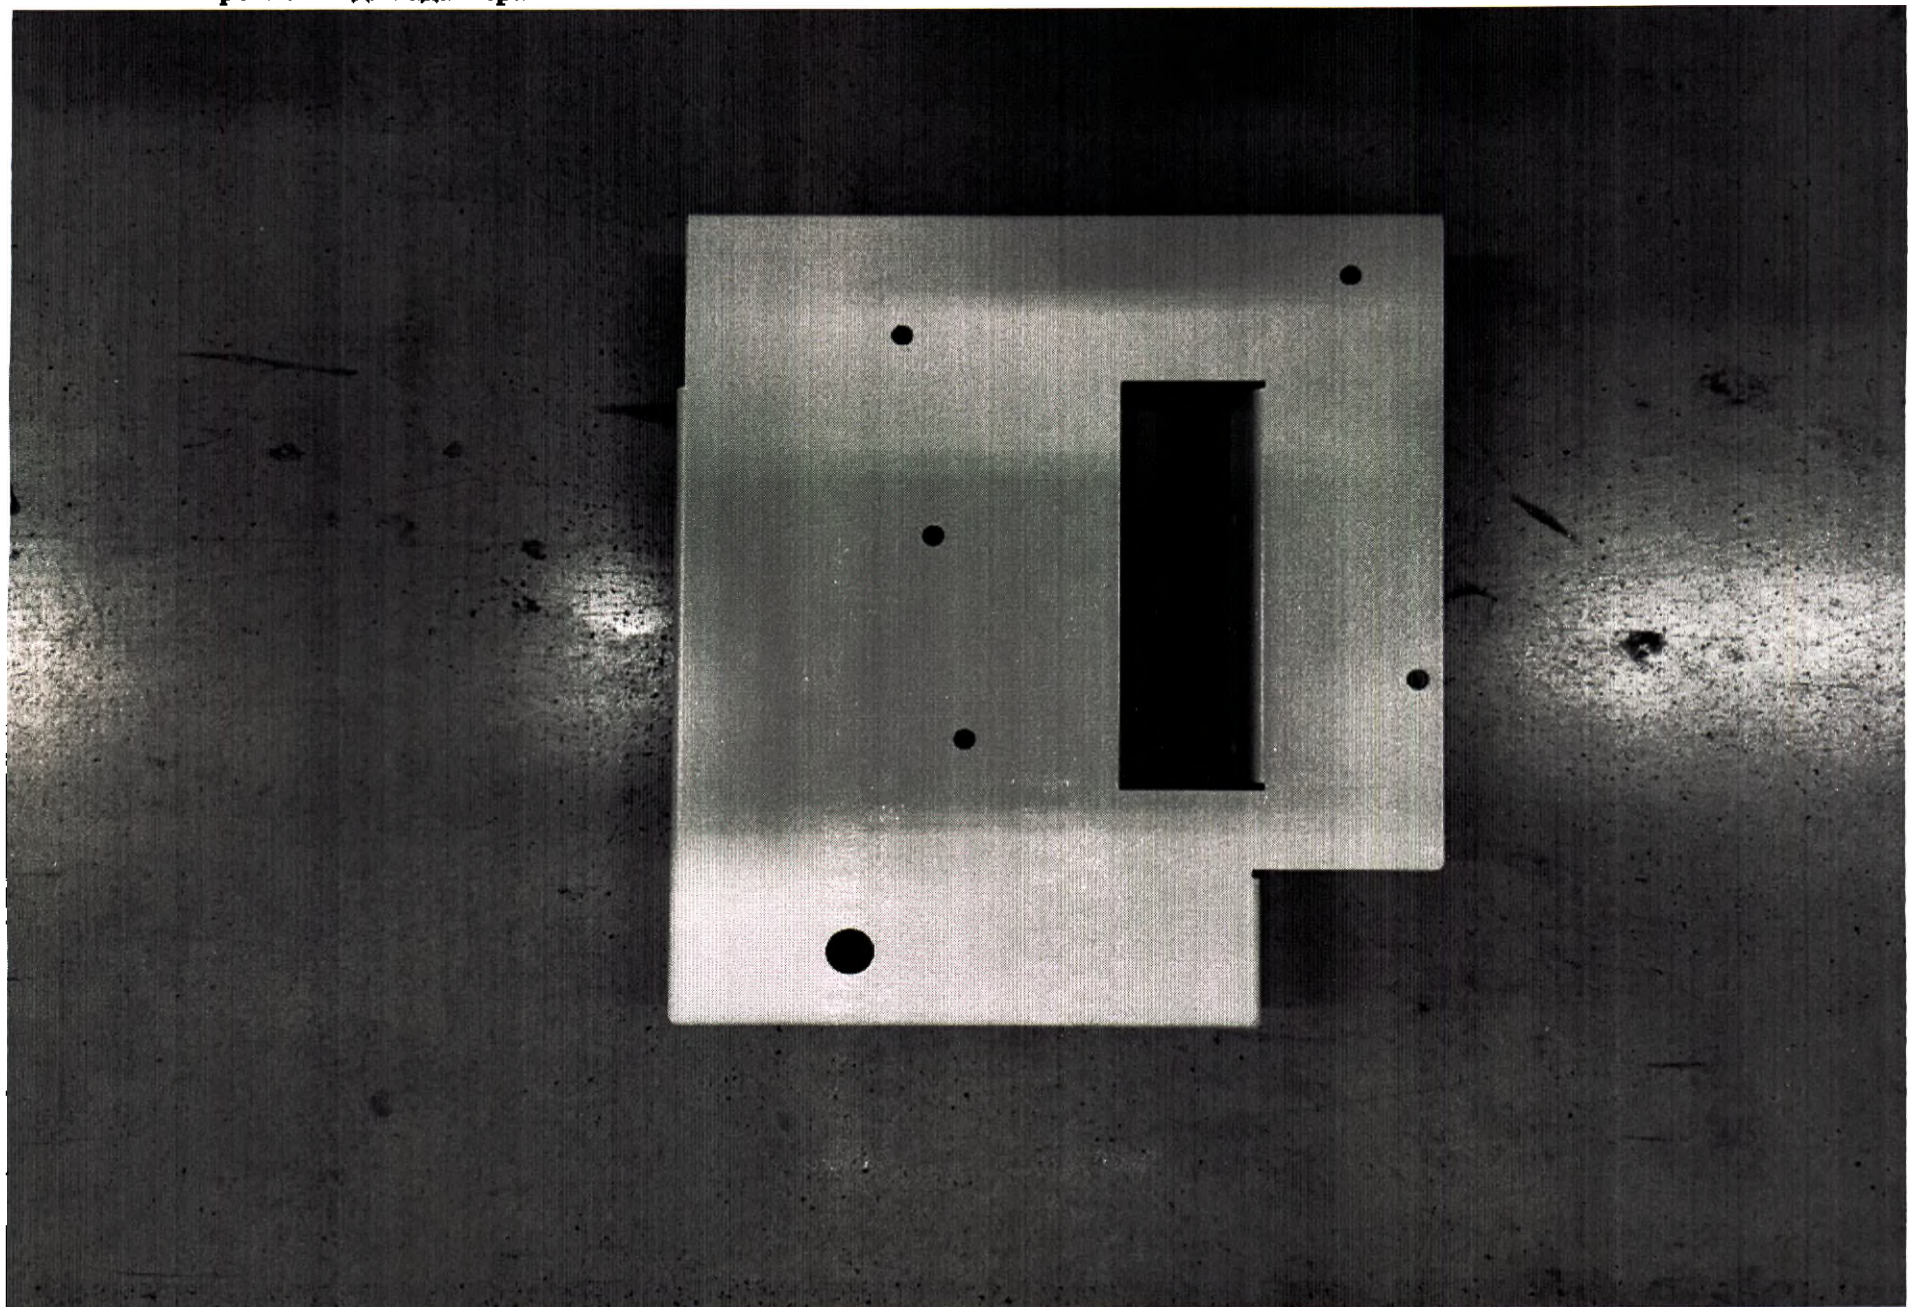


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку



16. Беспроводной USB-адаптер

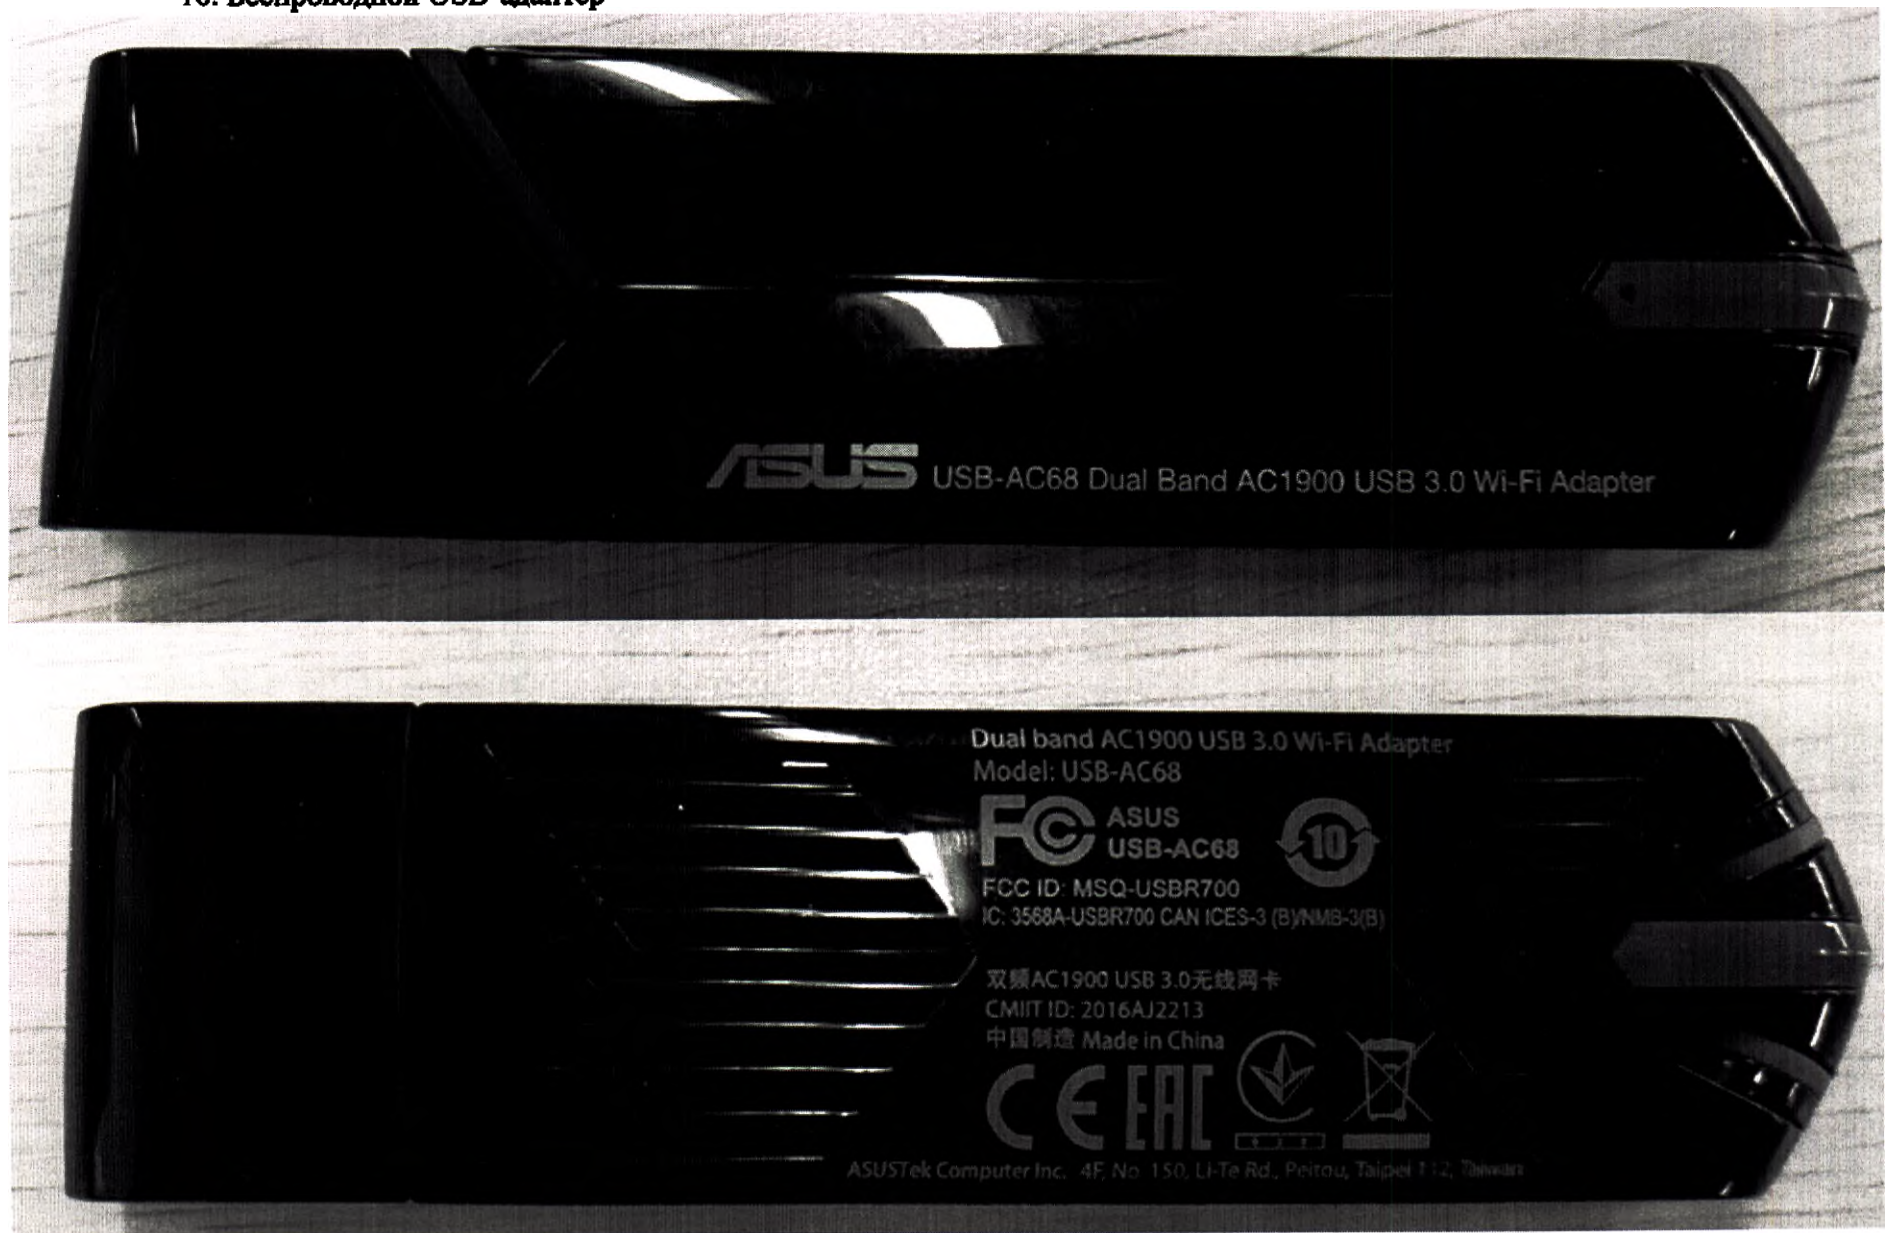


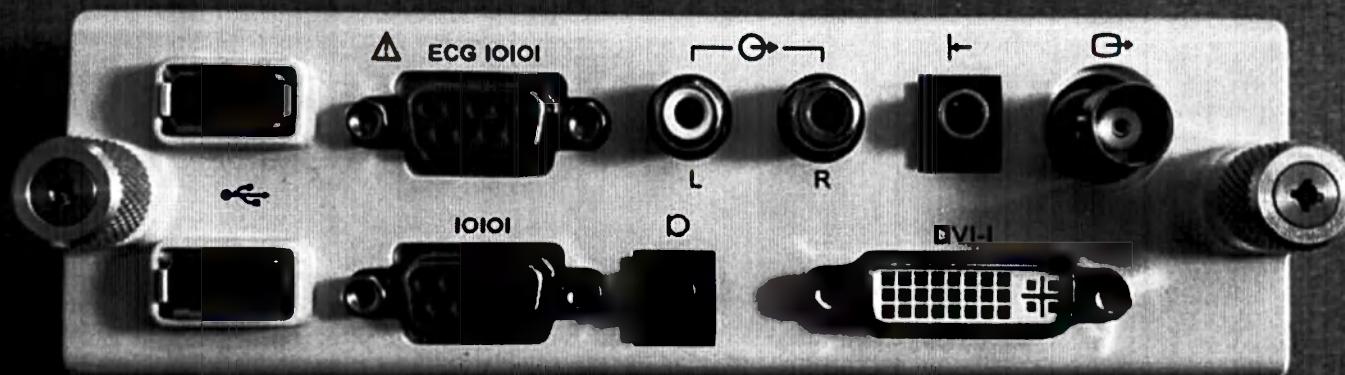

18. Кабель BNC




19. Кабель пульта дистанционного управления принтером

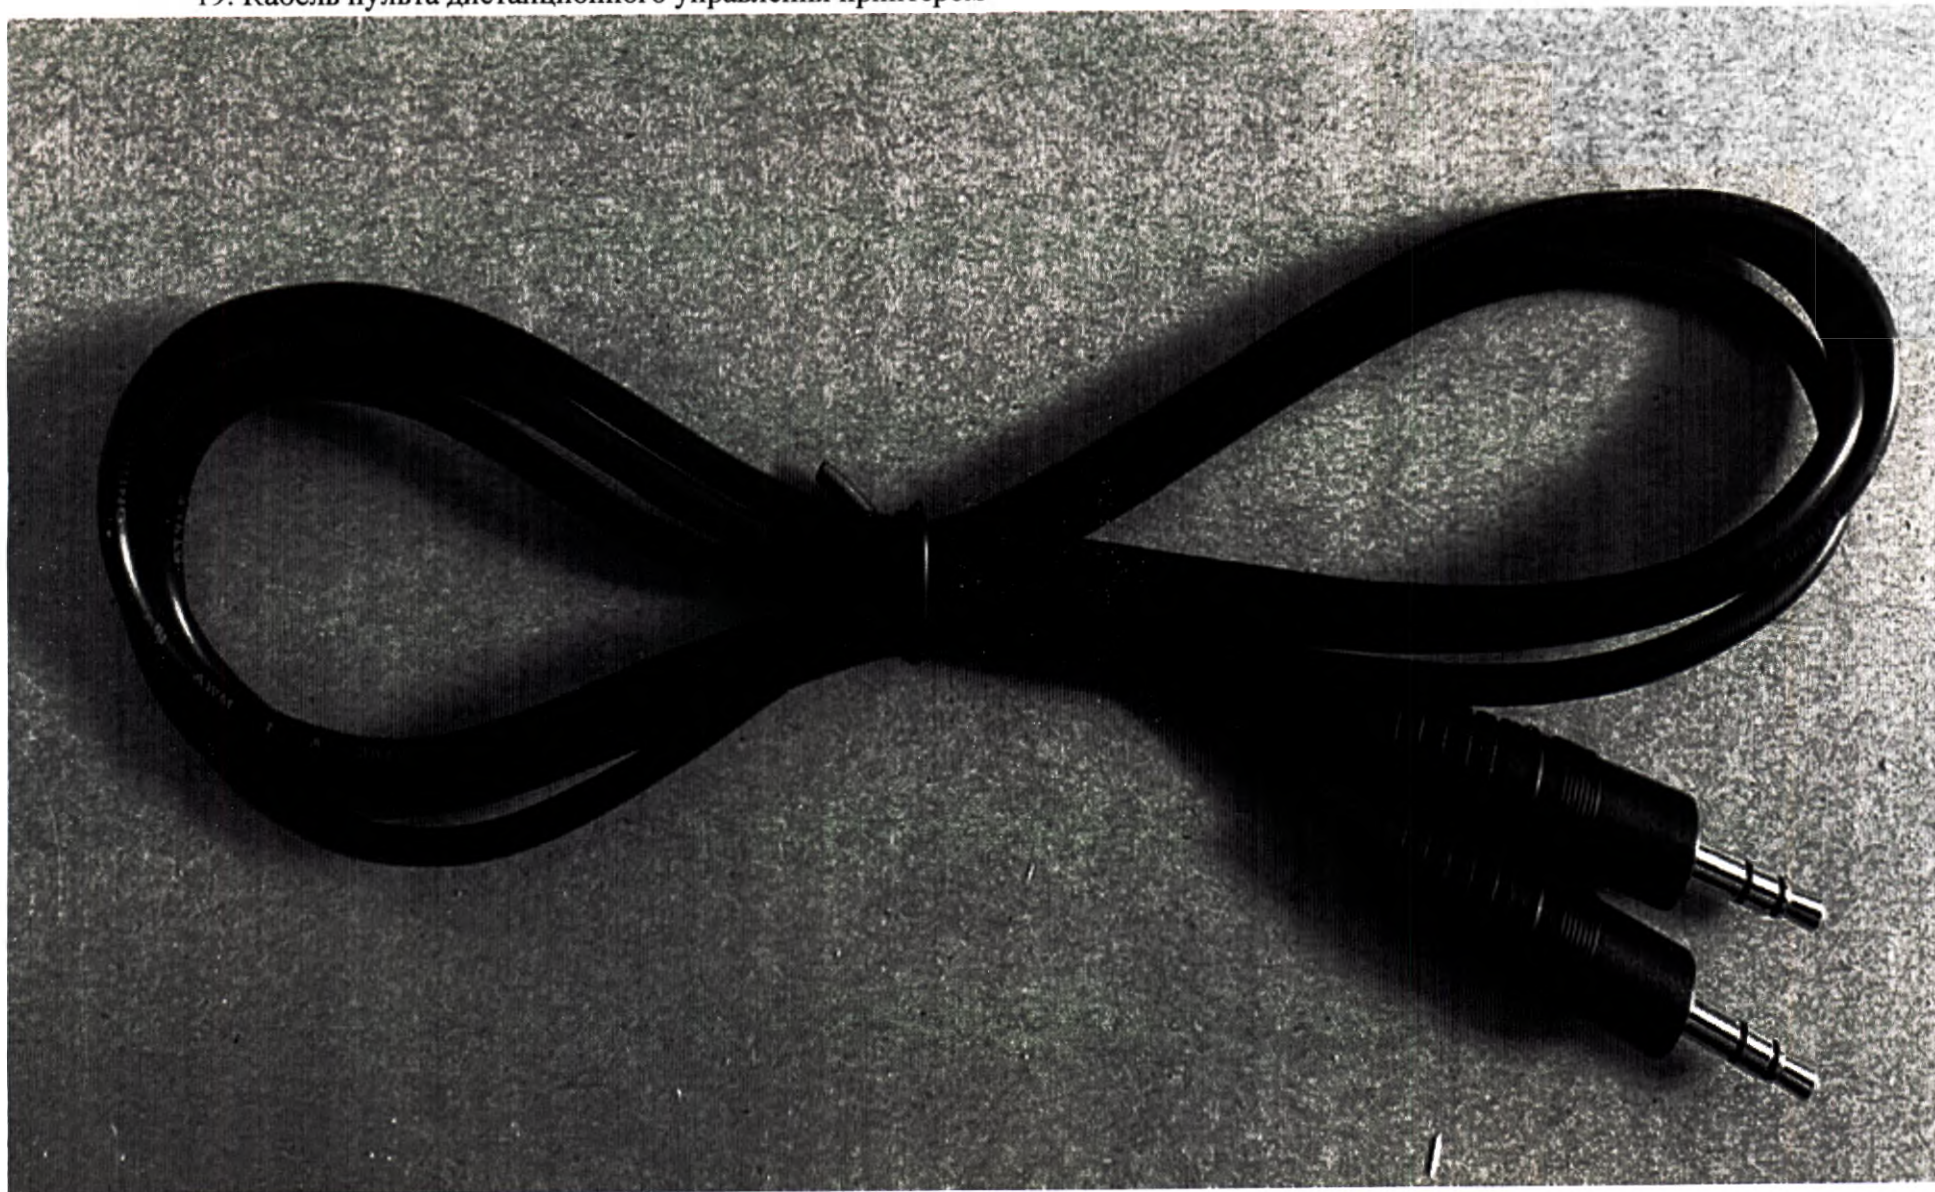



21. Сумка



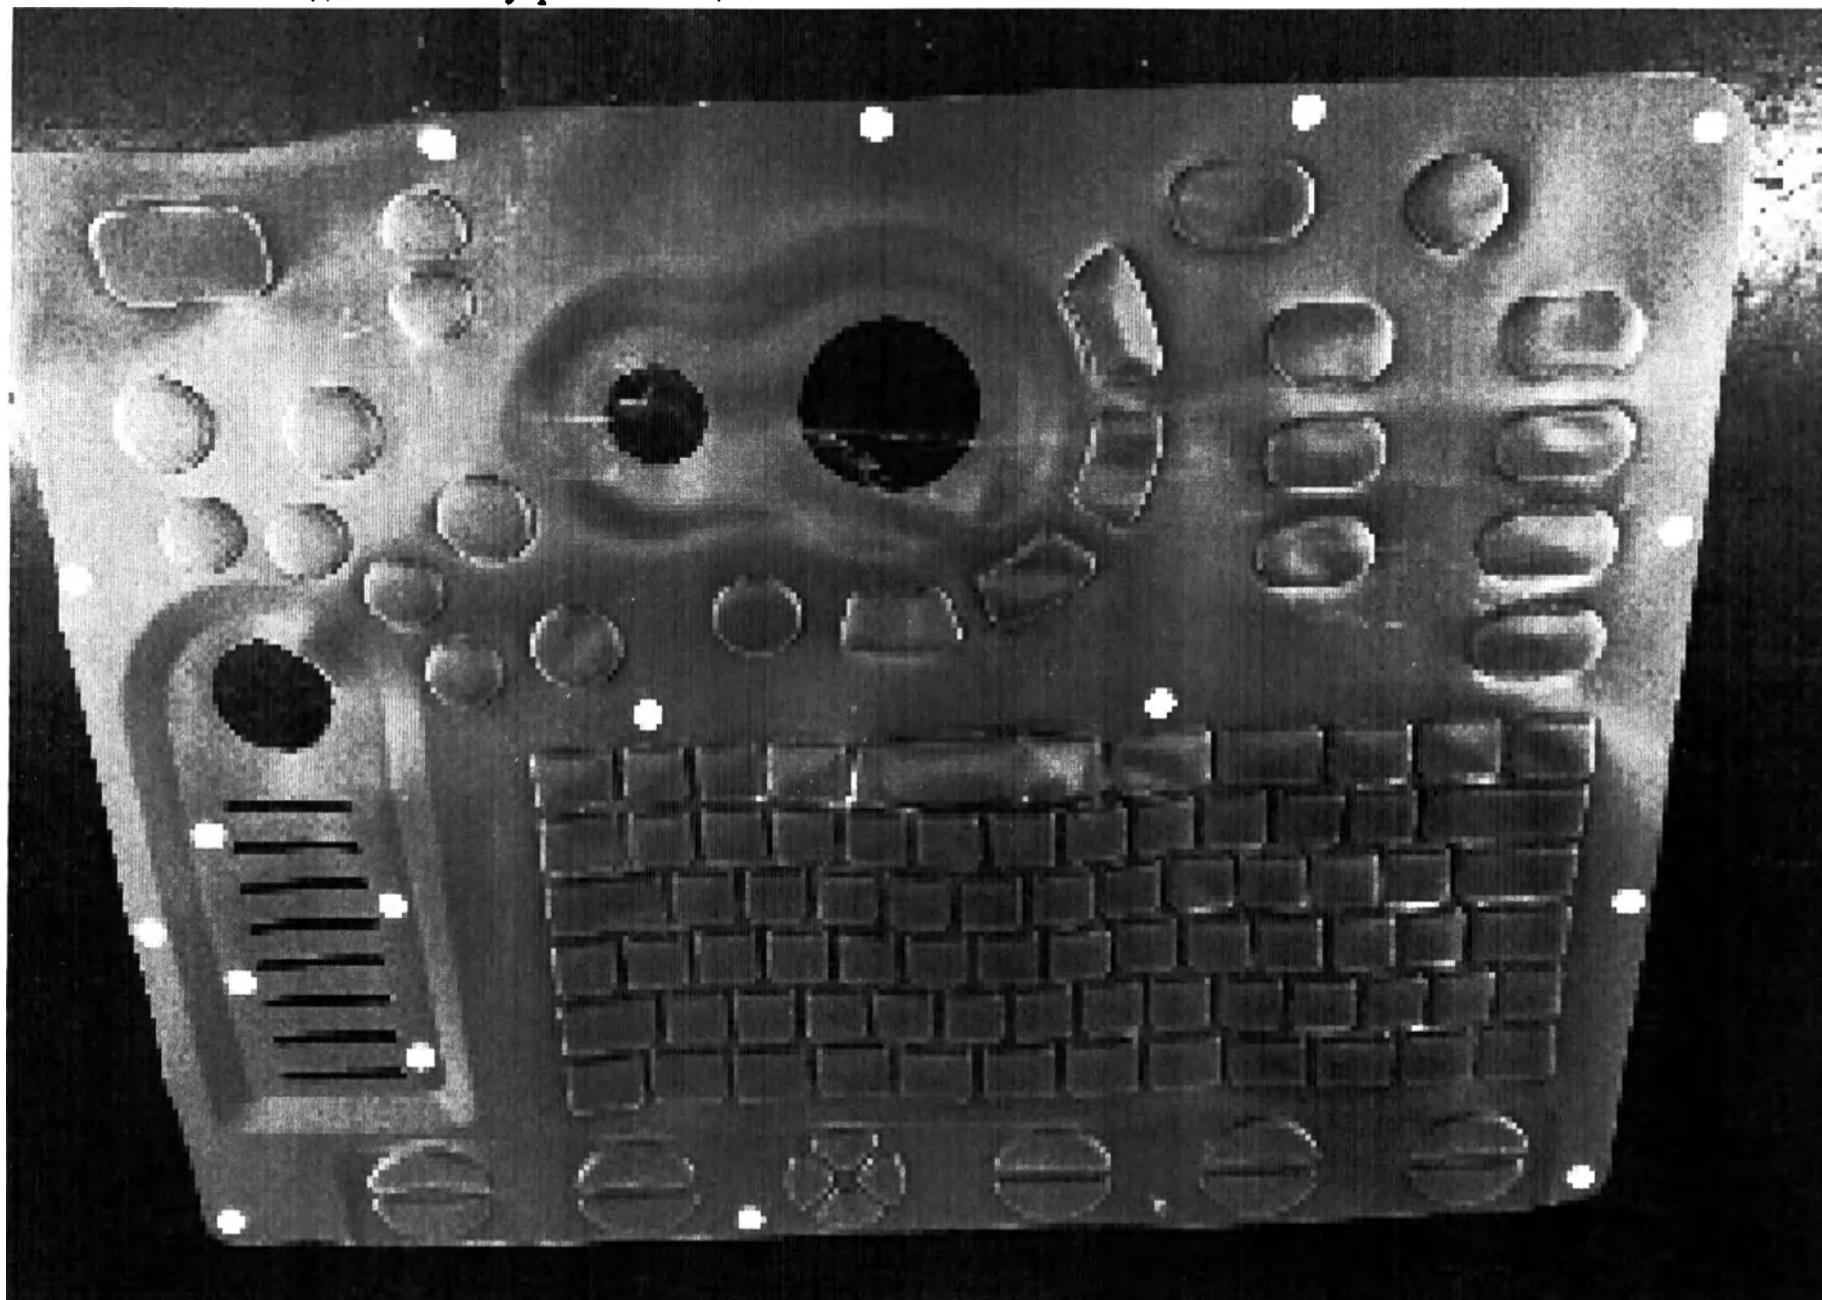



24. Датчики ультразвуковые

24.1. Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s





24.2. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5s




24.3. Датчик ультразвуковой конвексный объемный 4CD4s



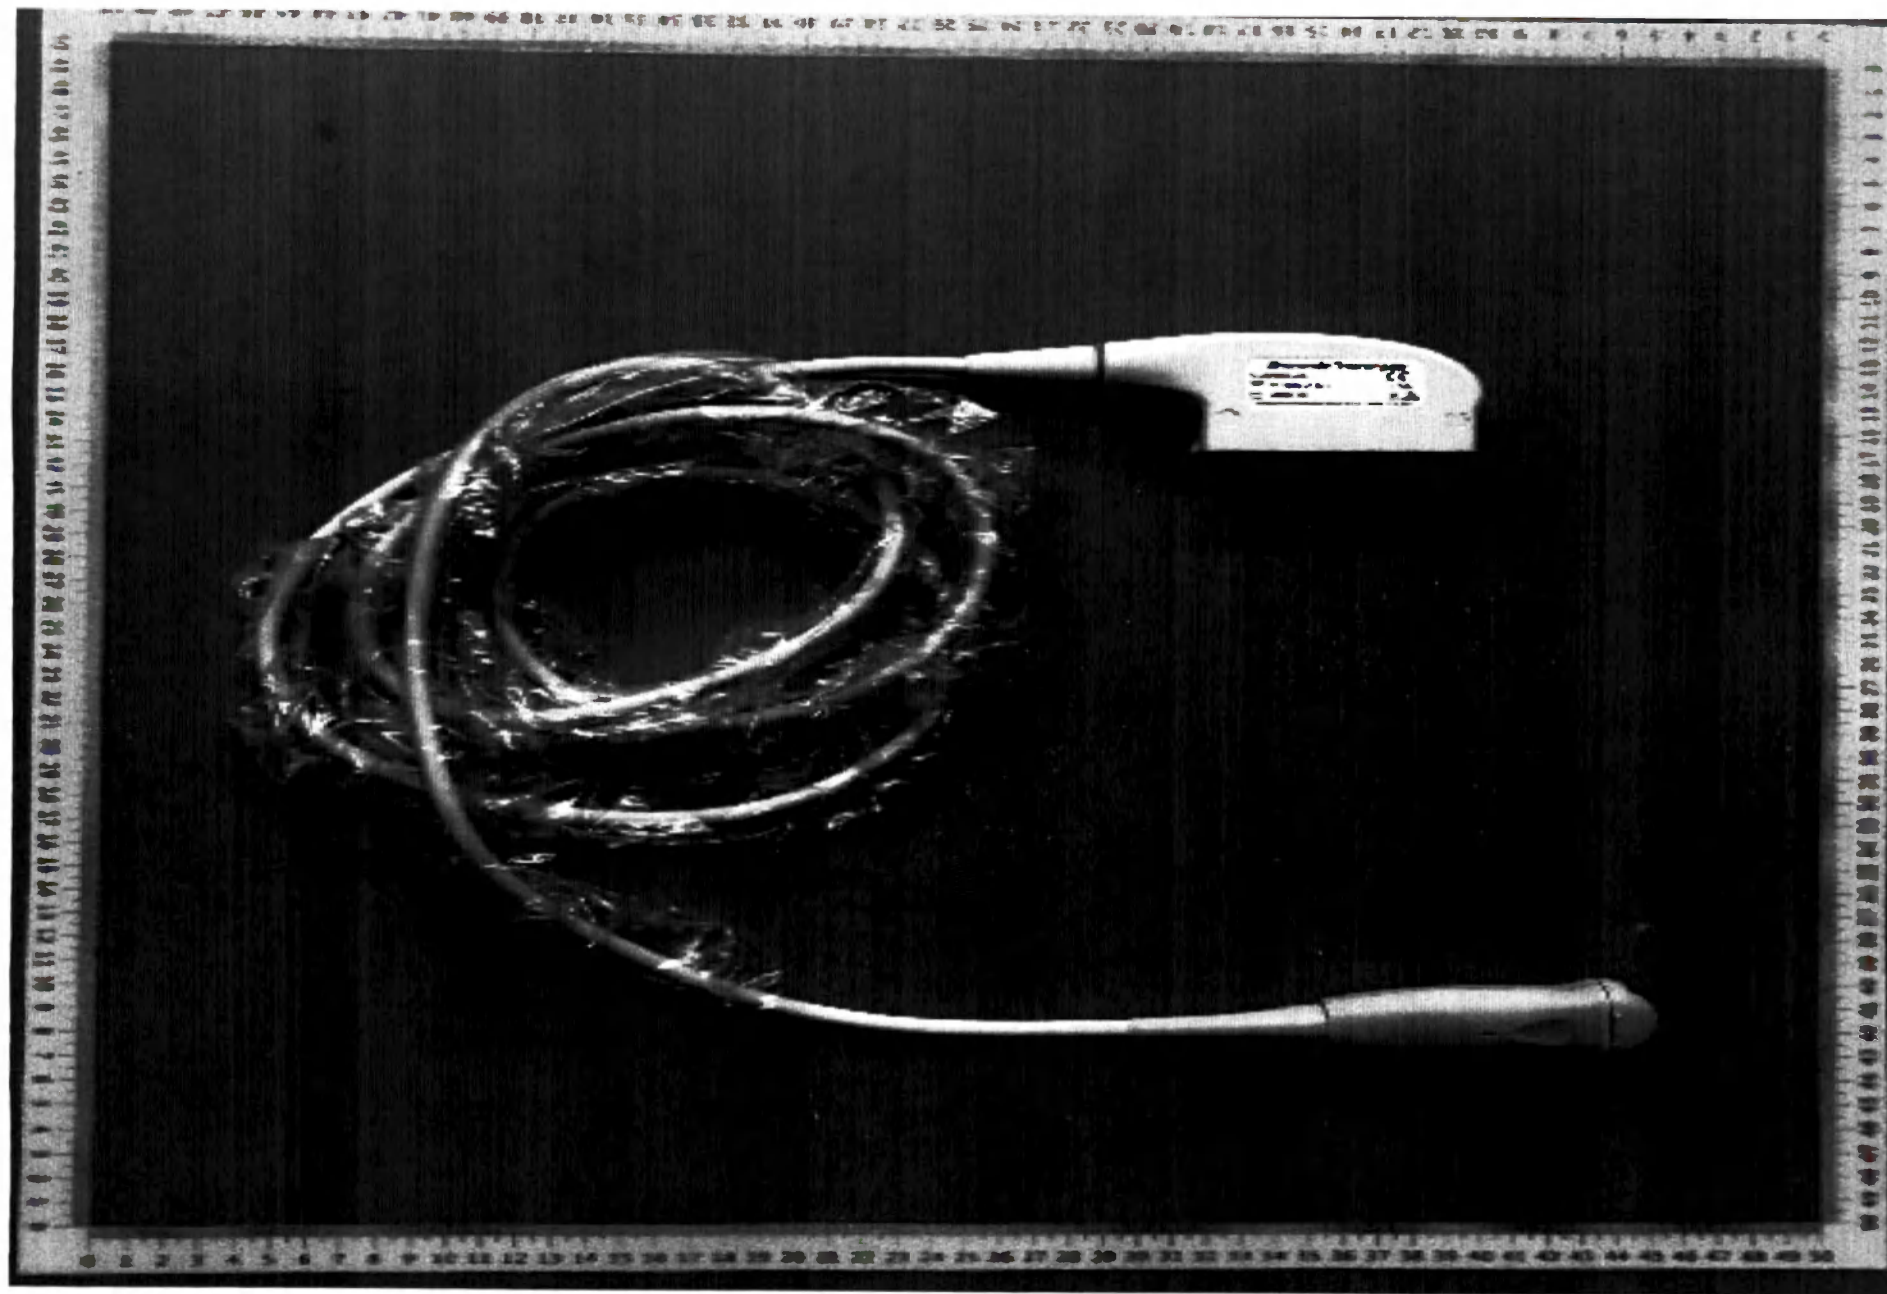

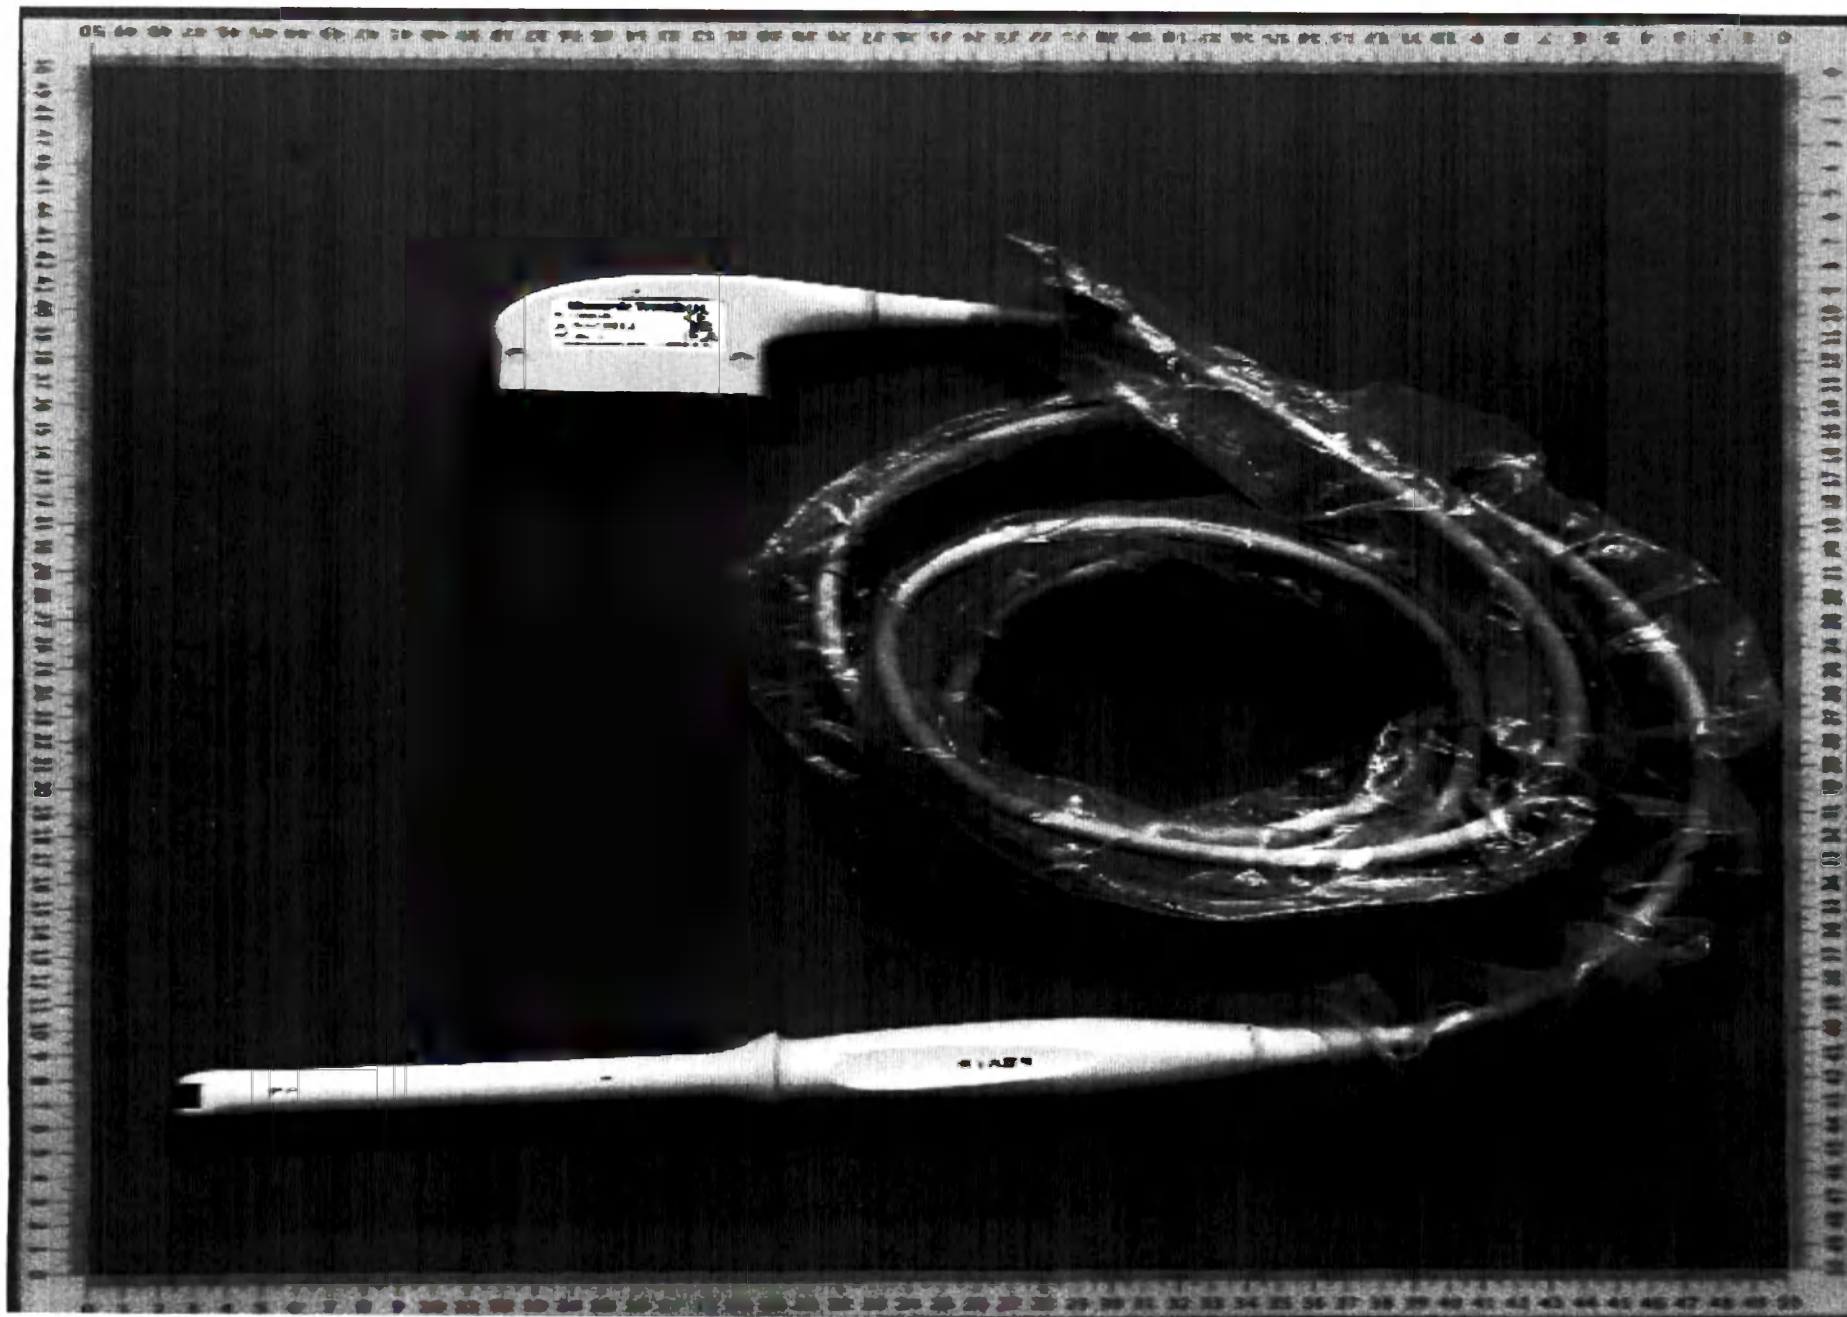


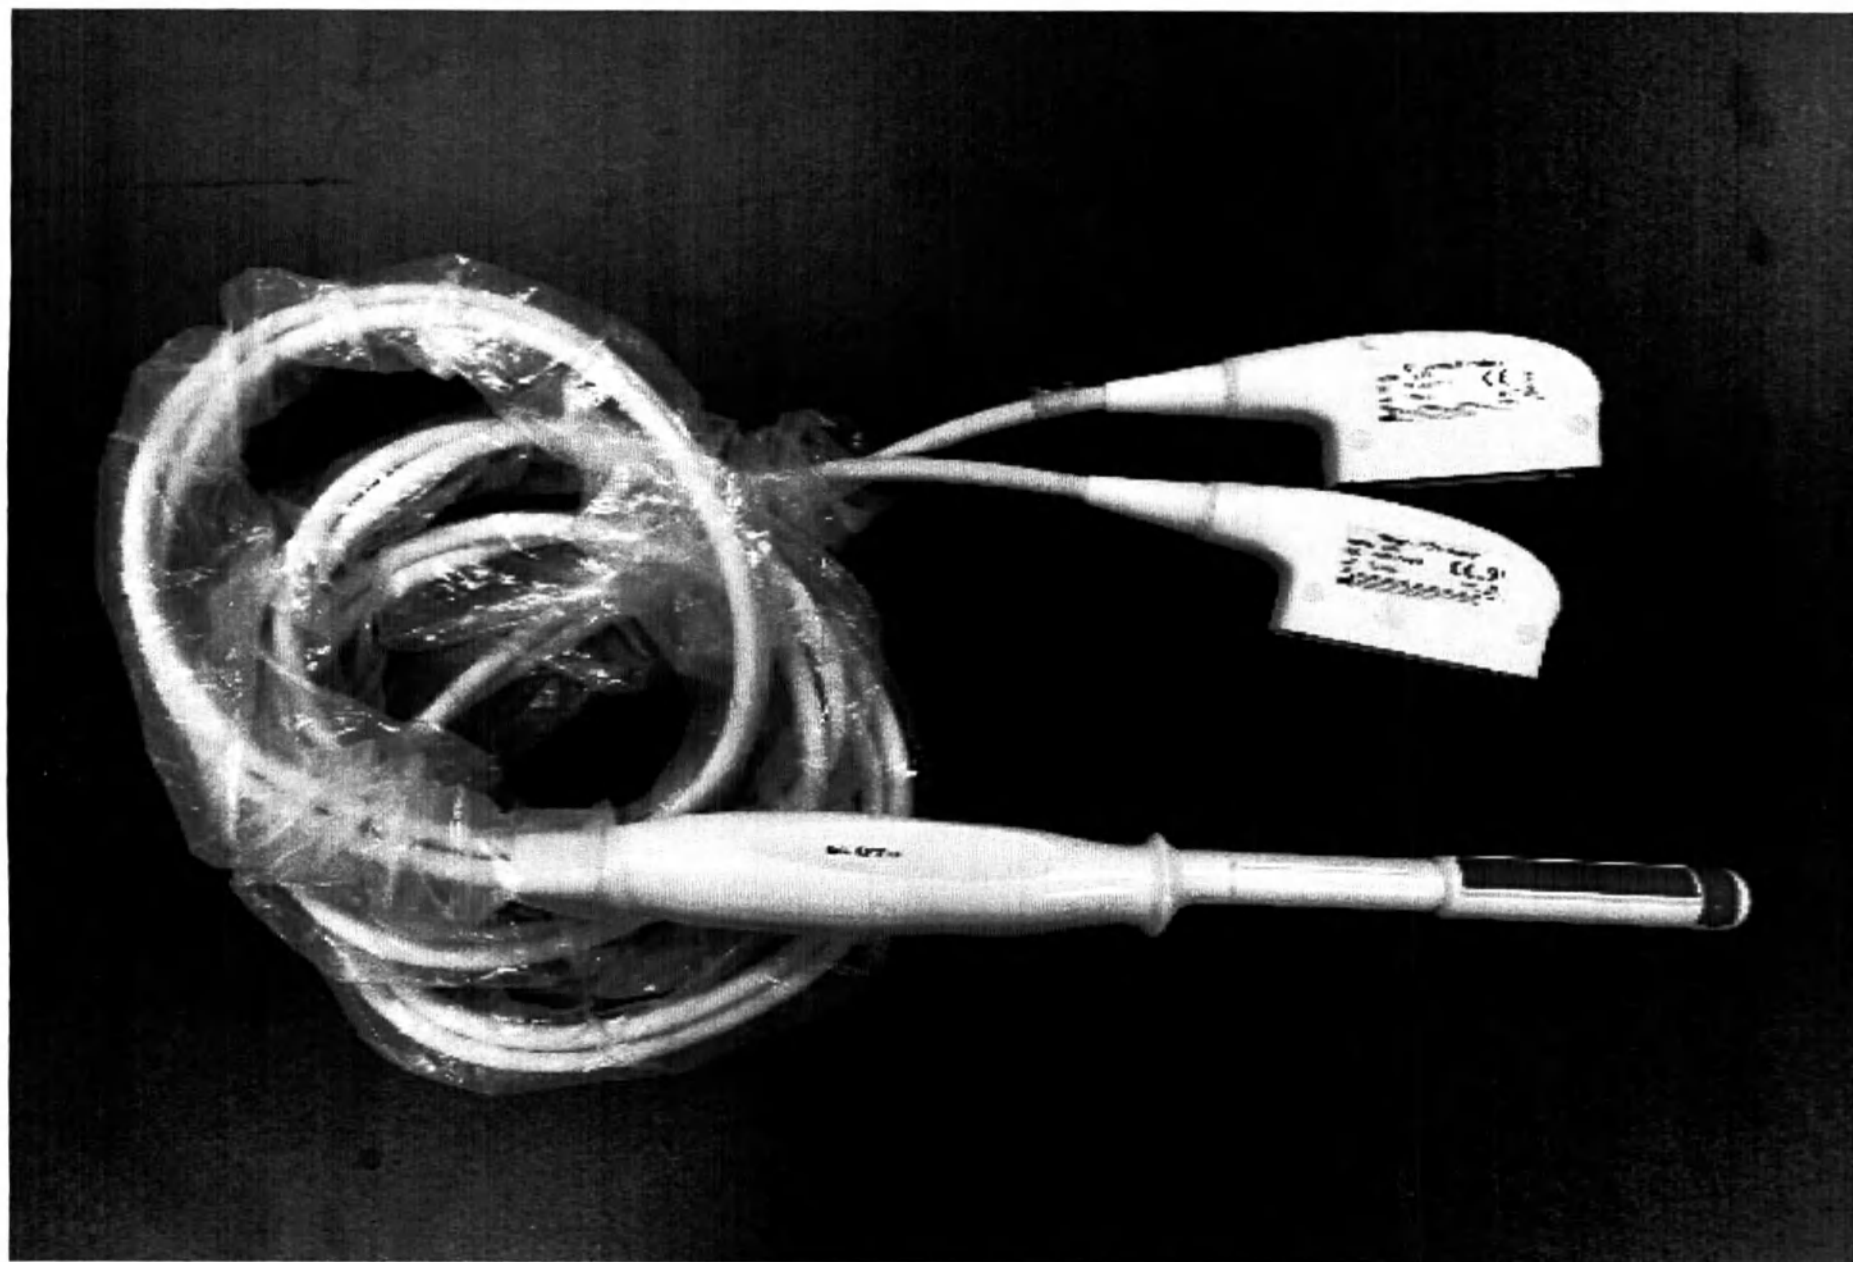









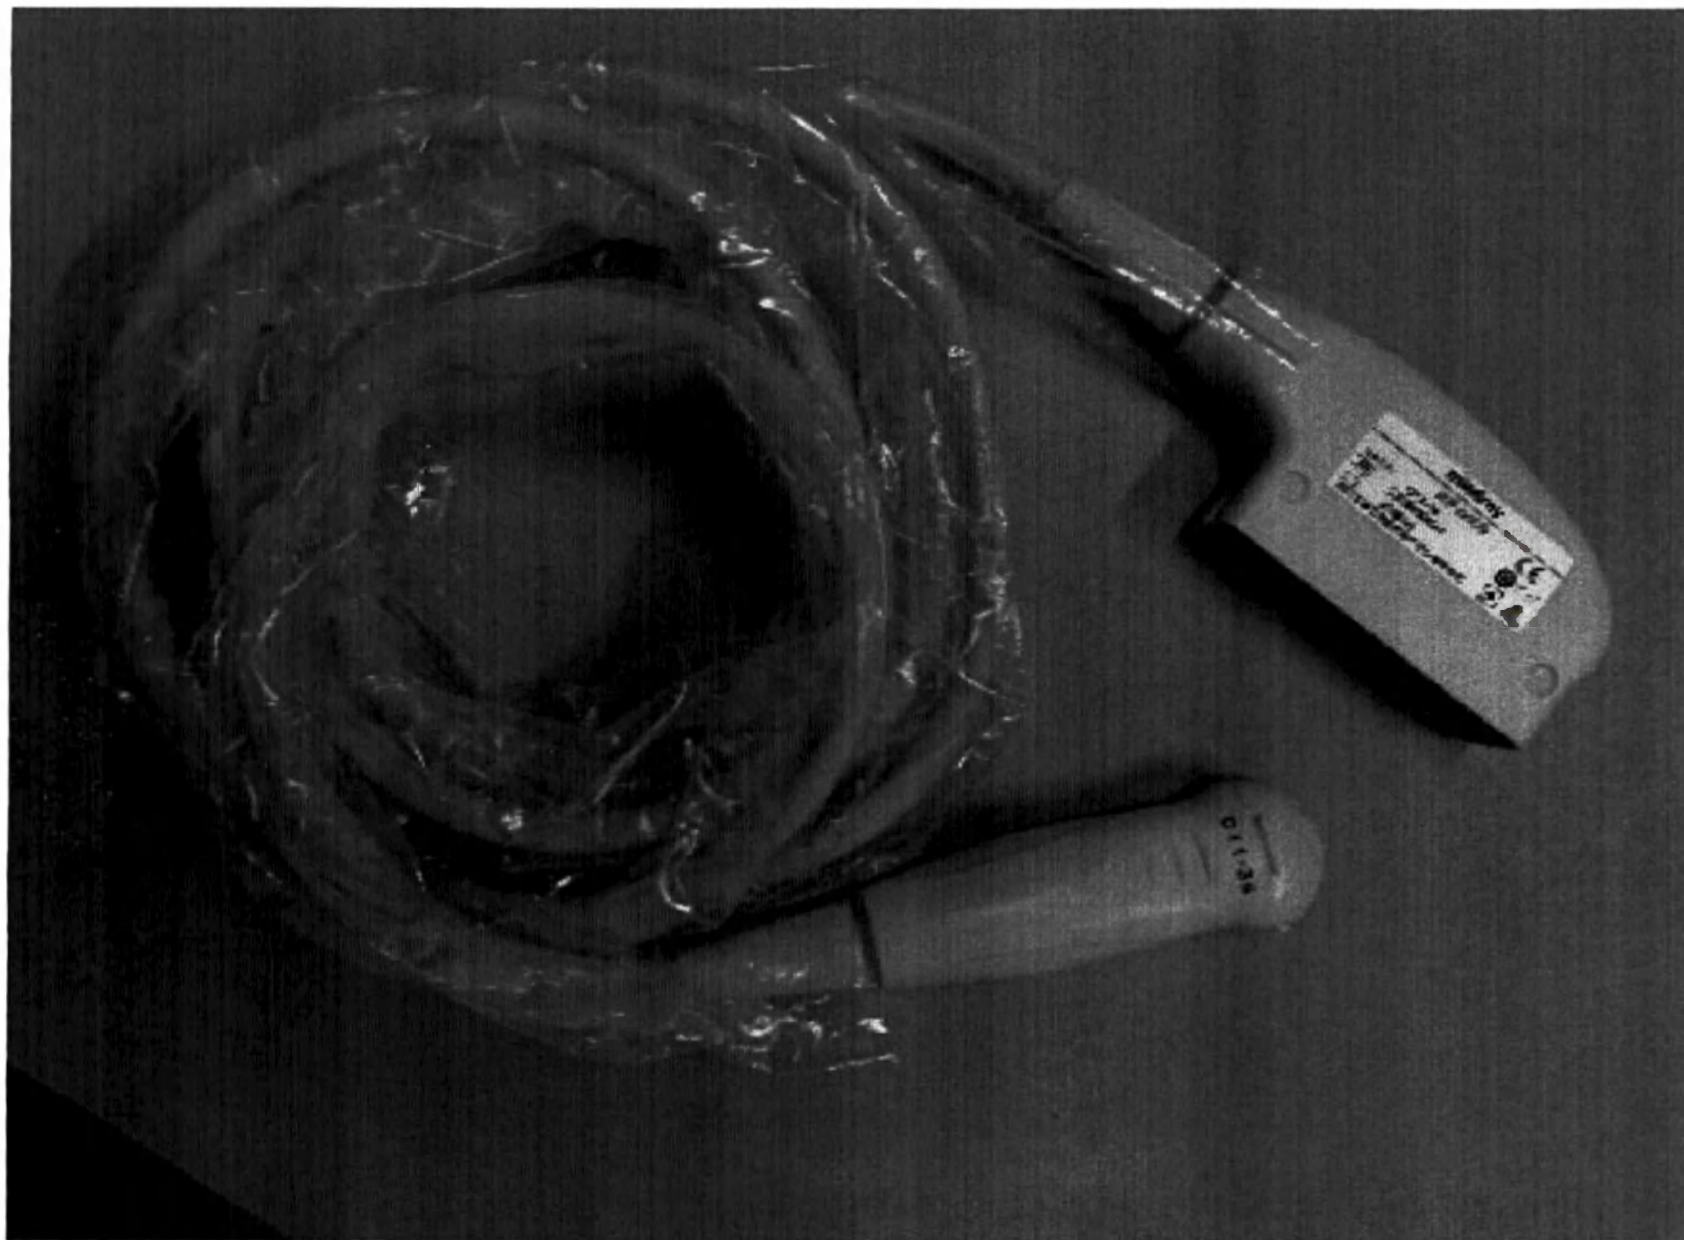




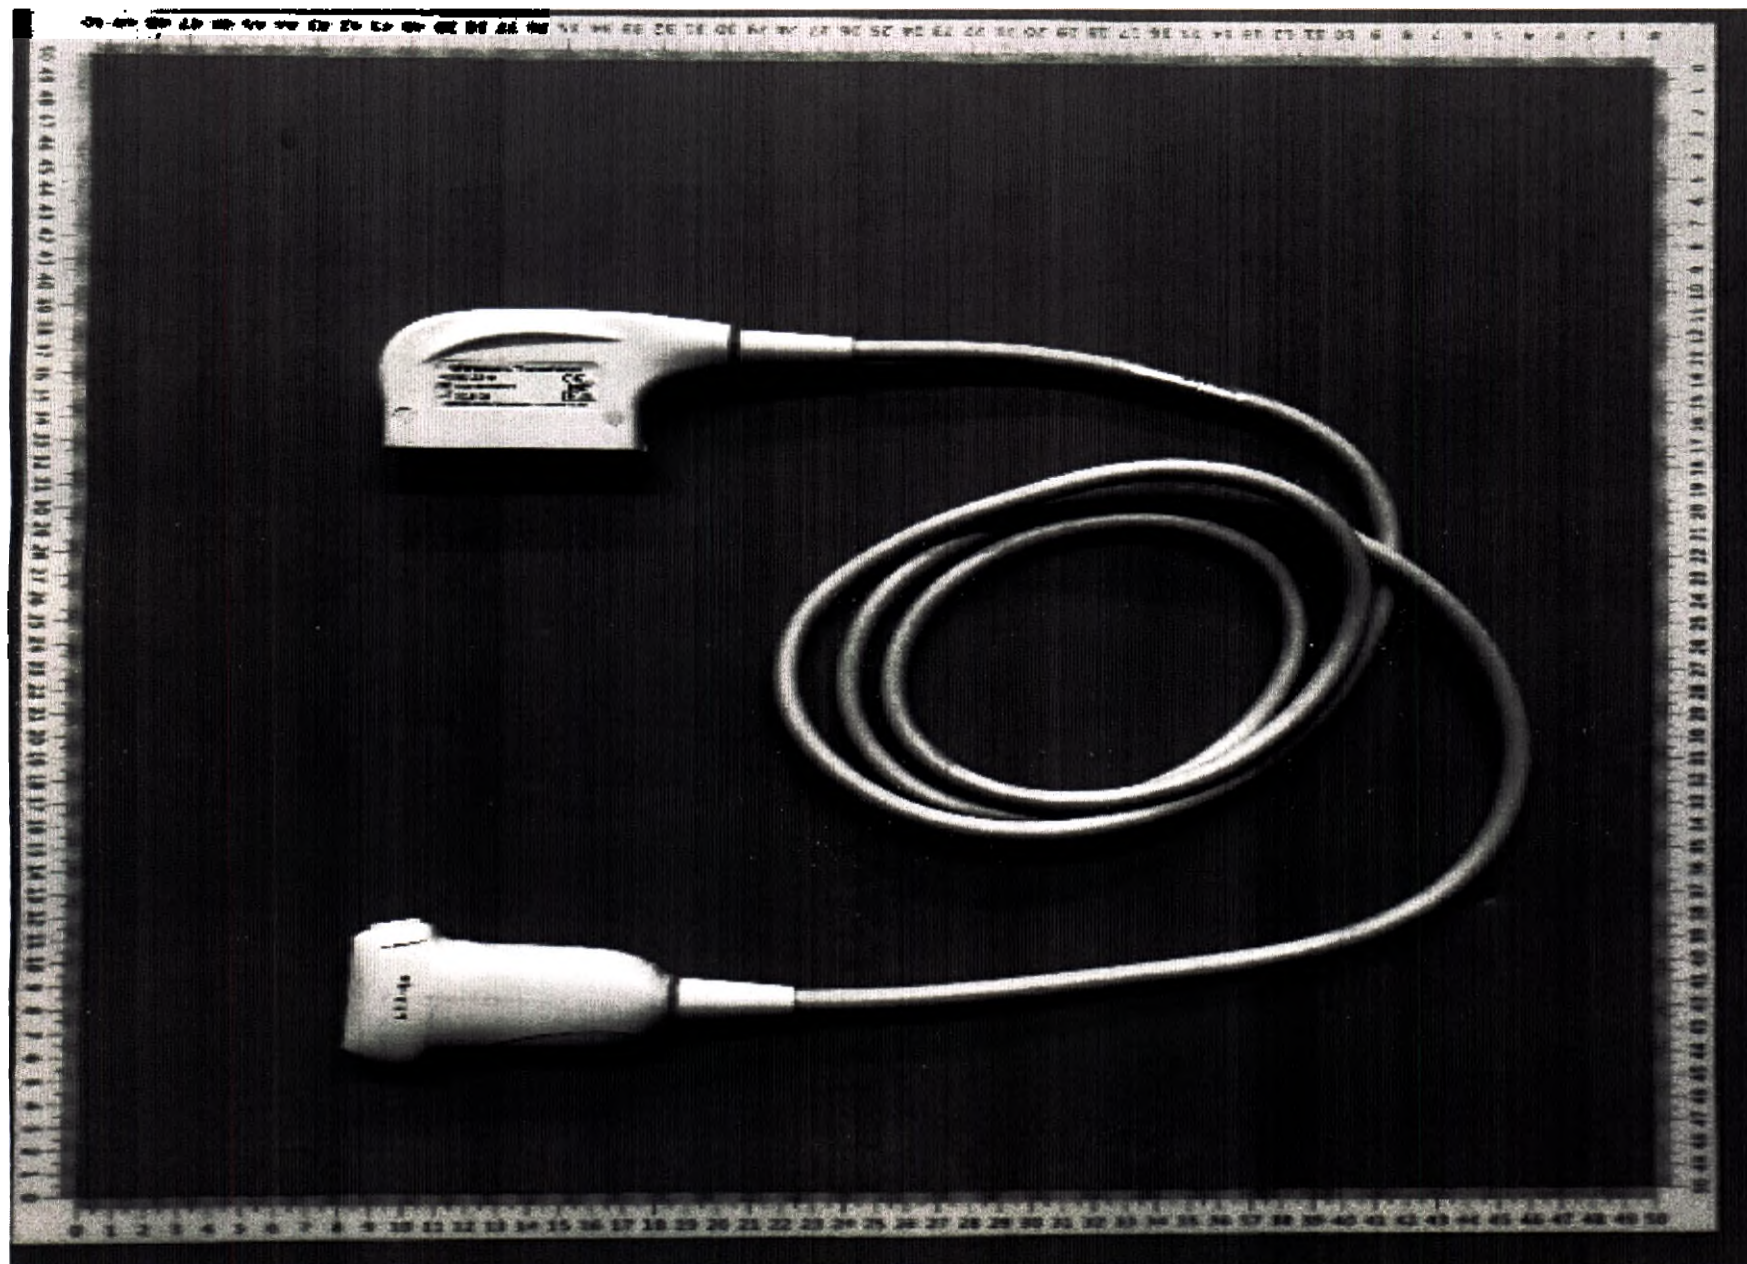


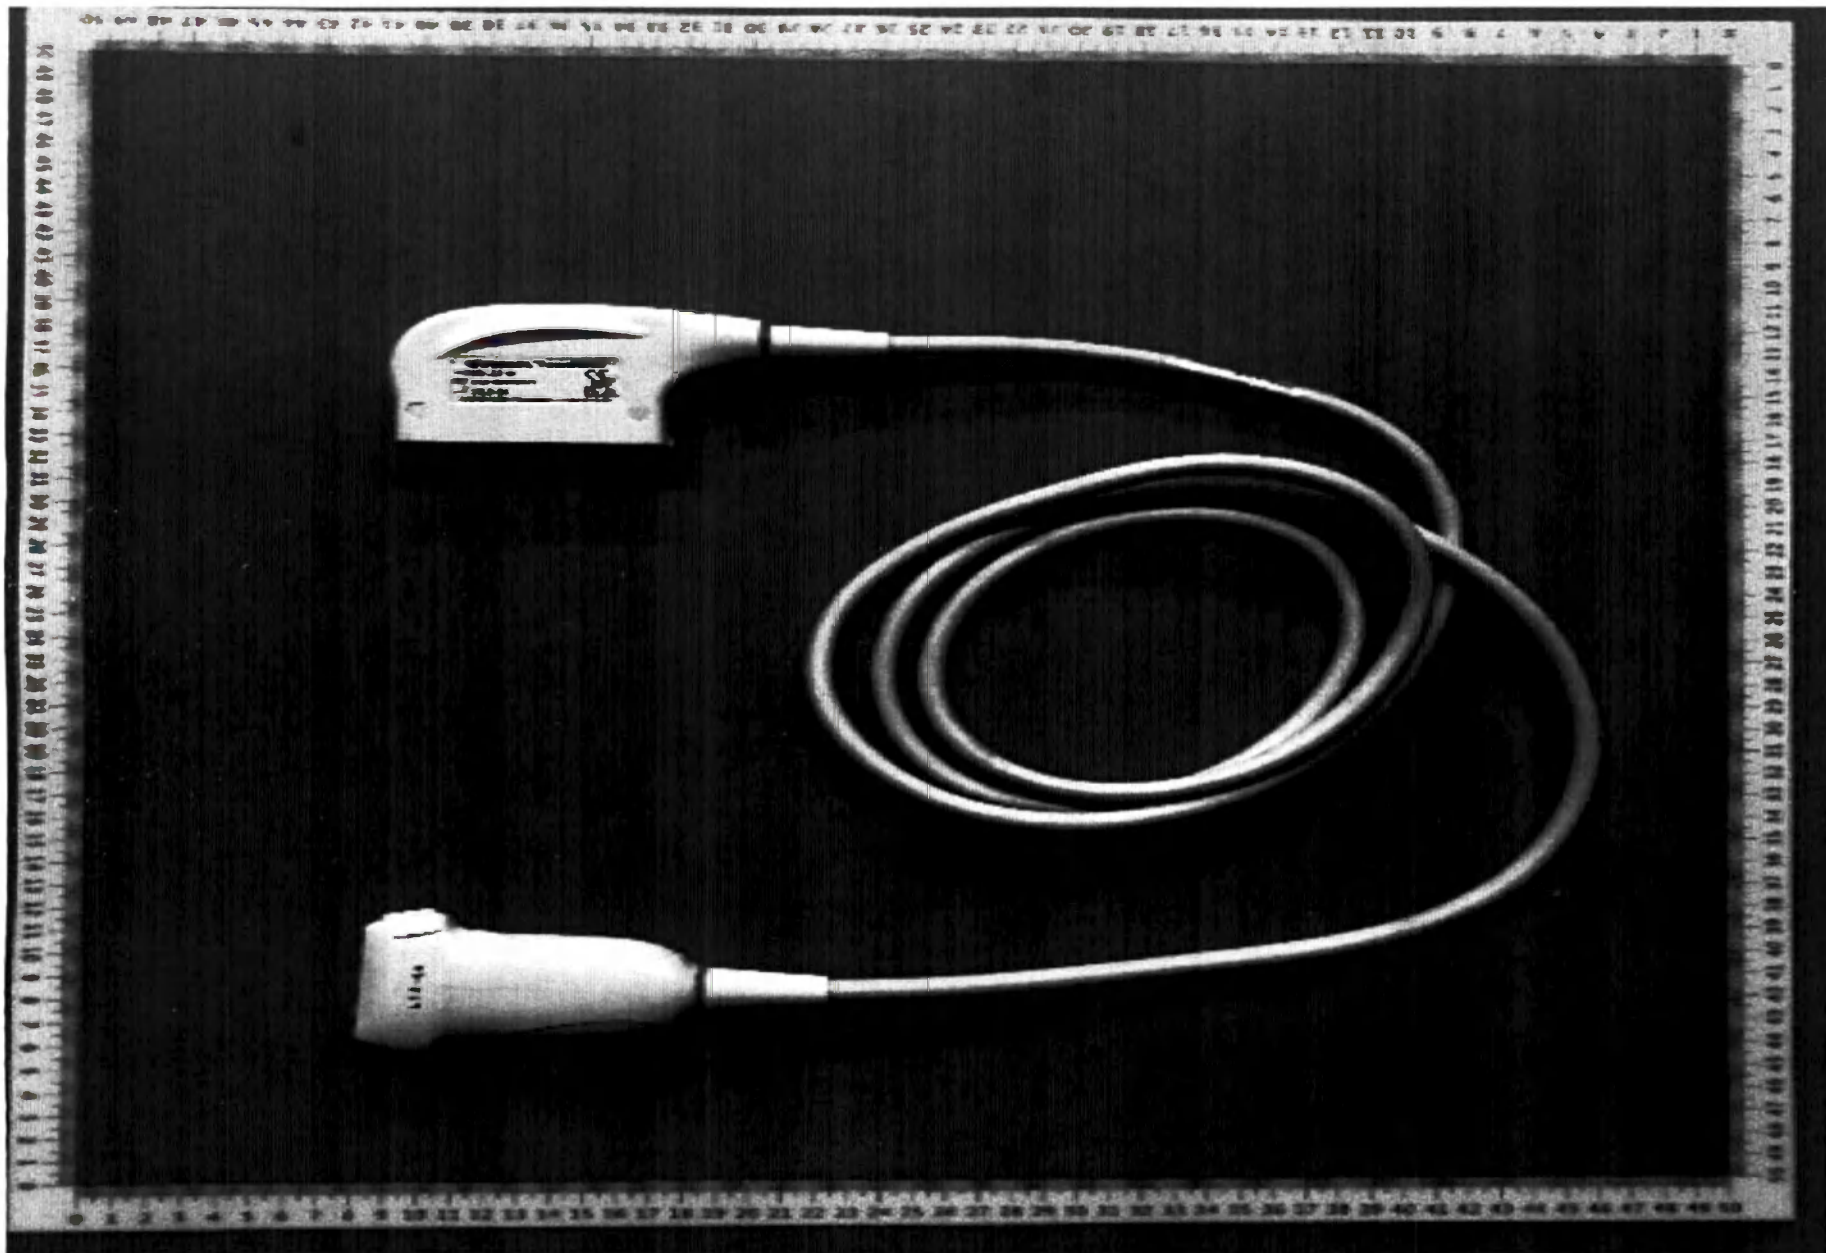



24.14. Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

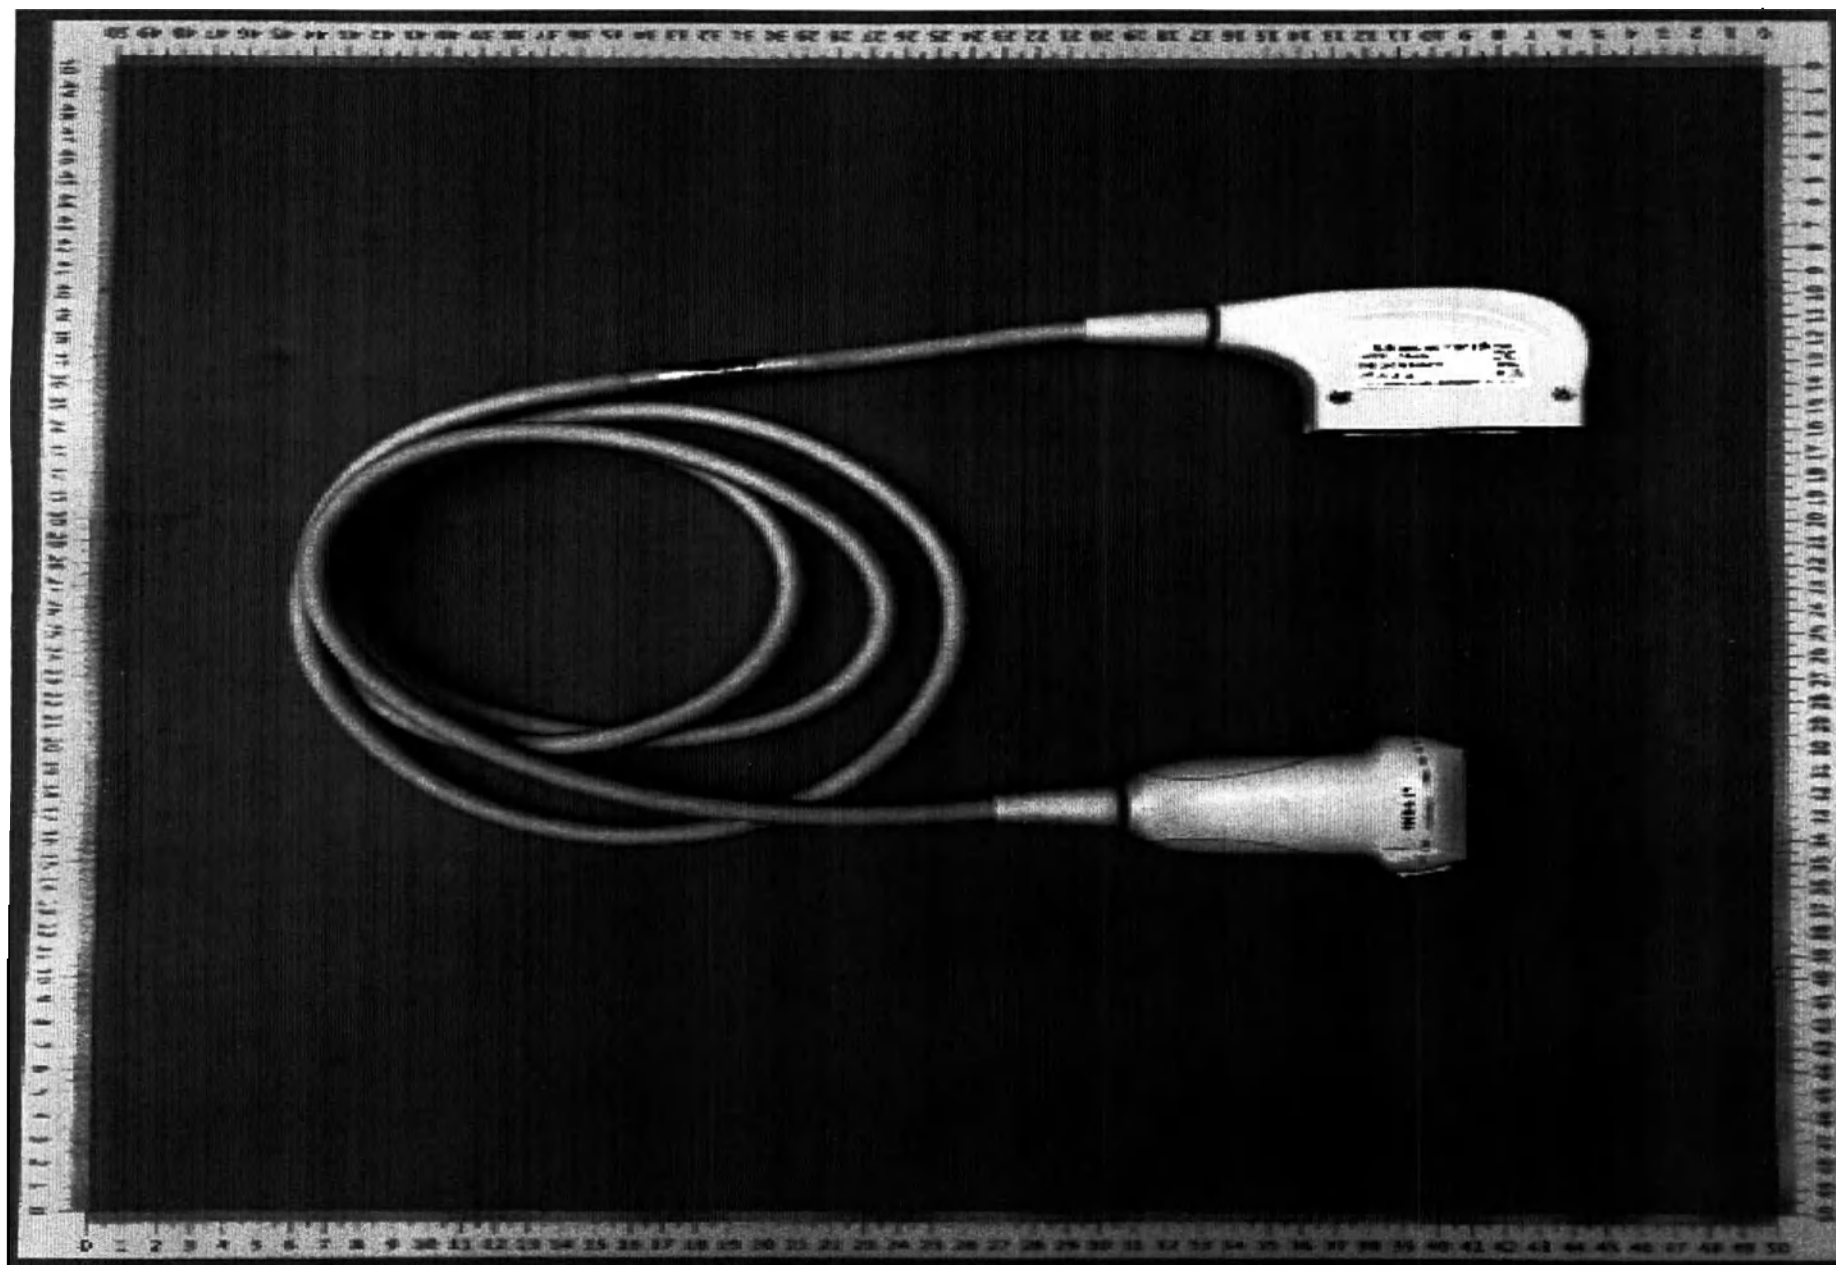




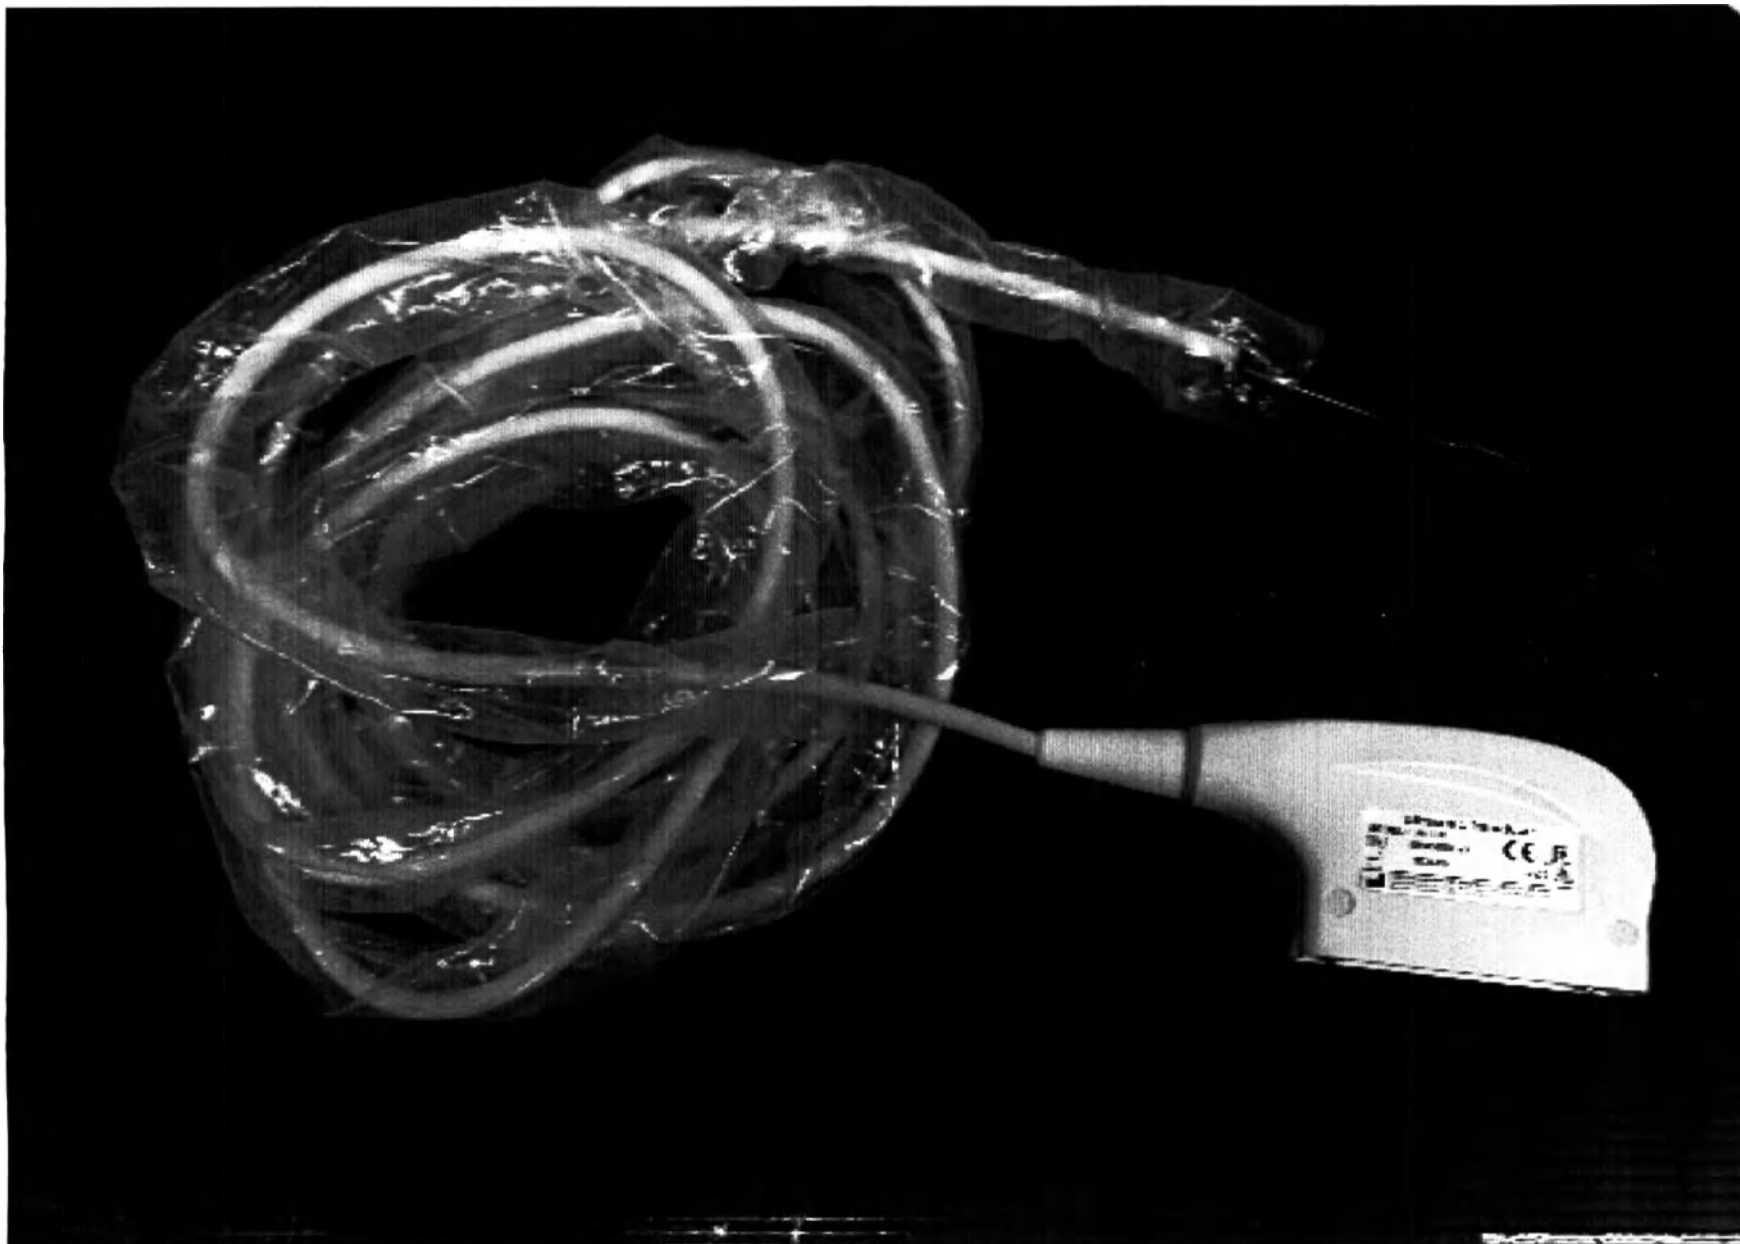

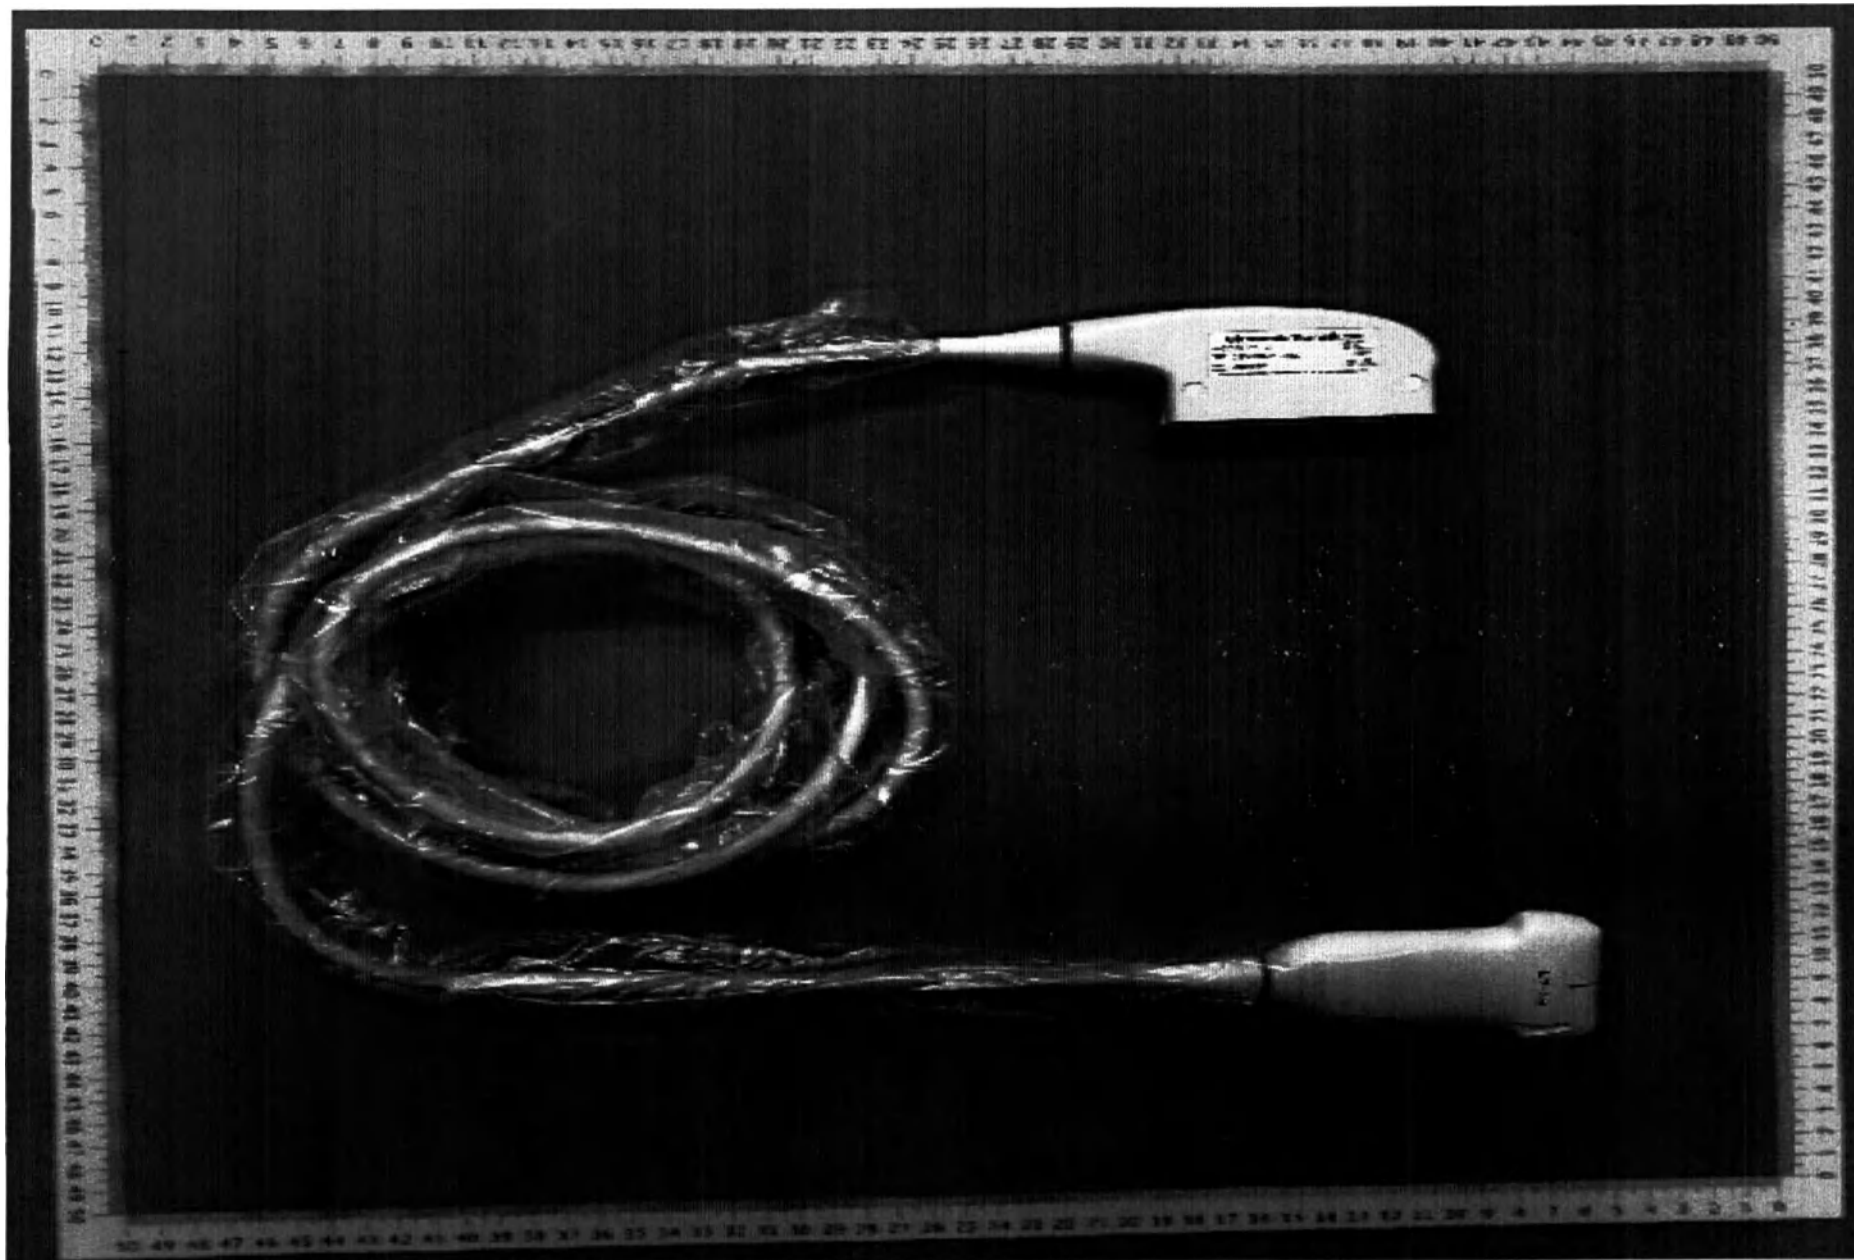

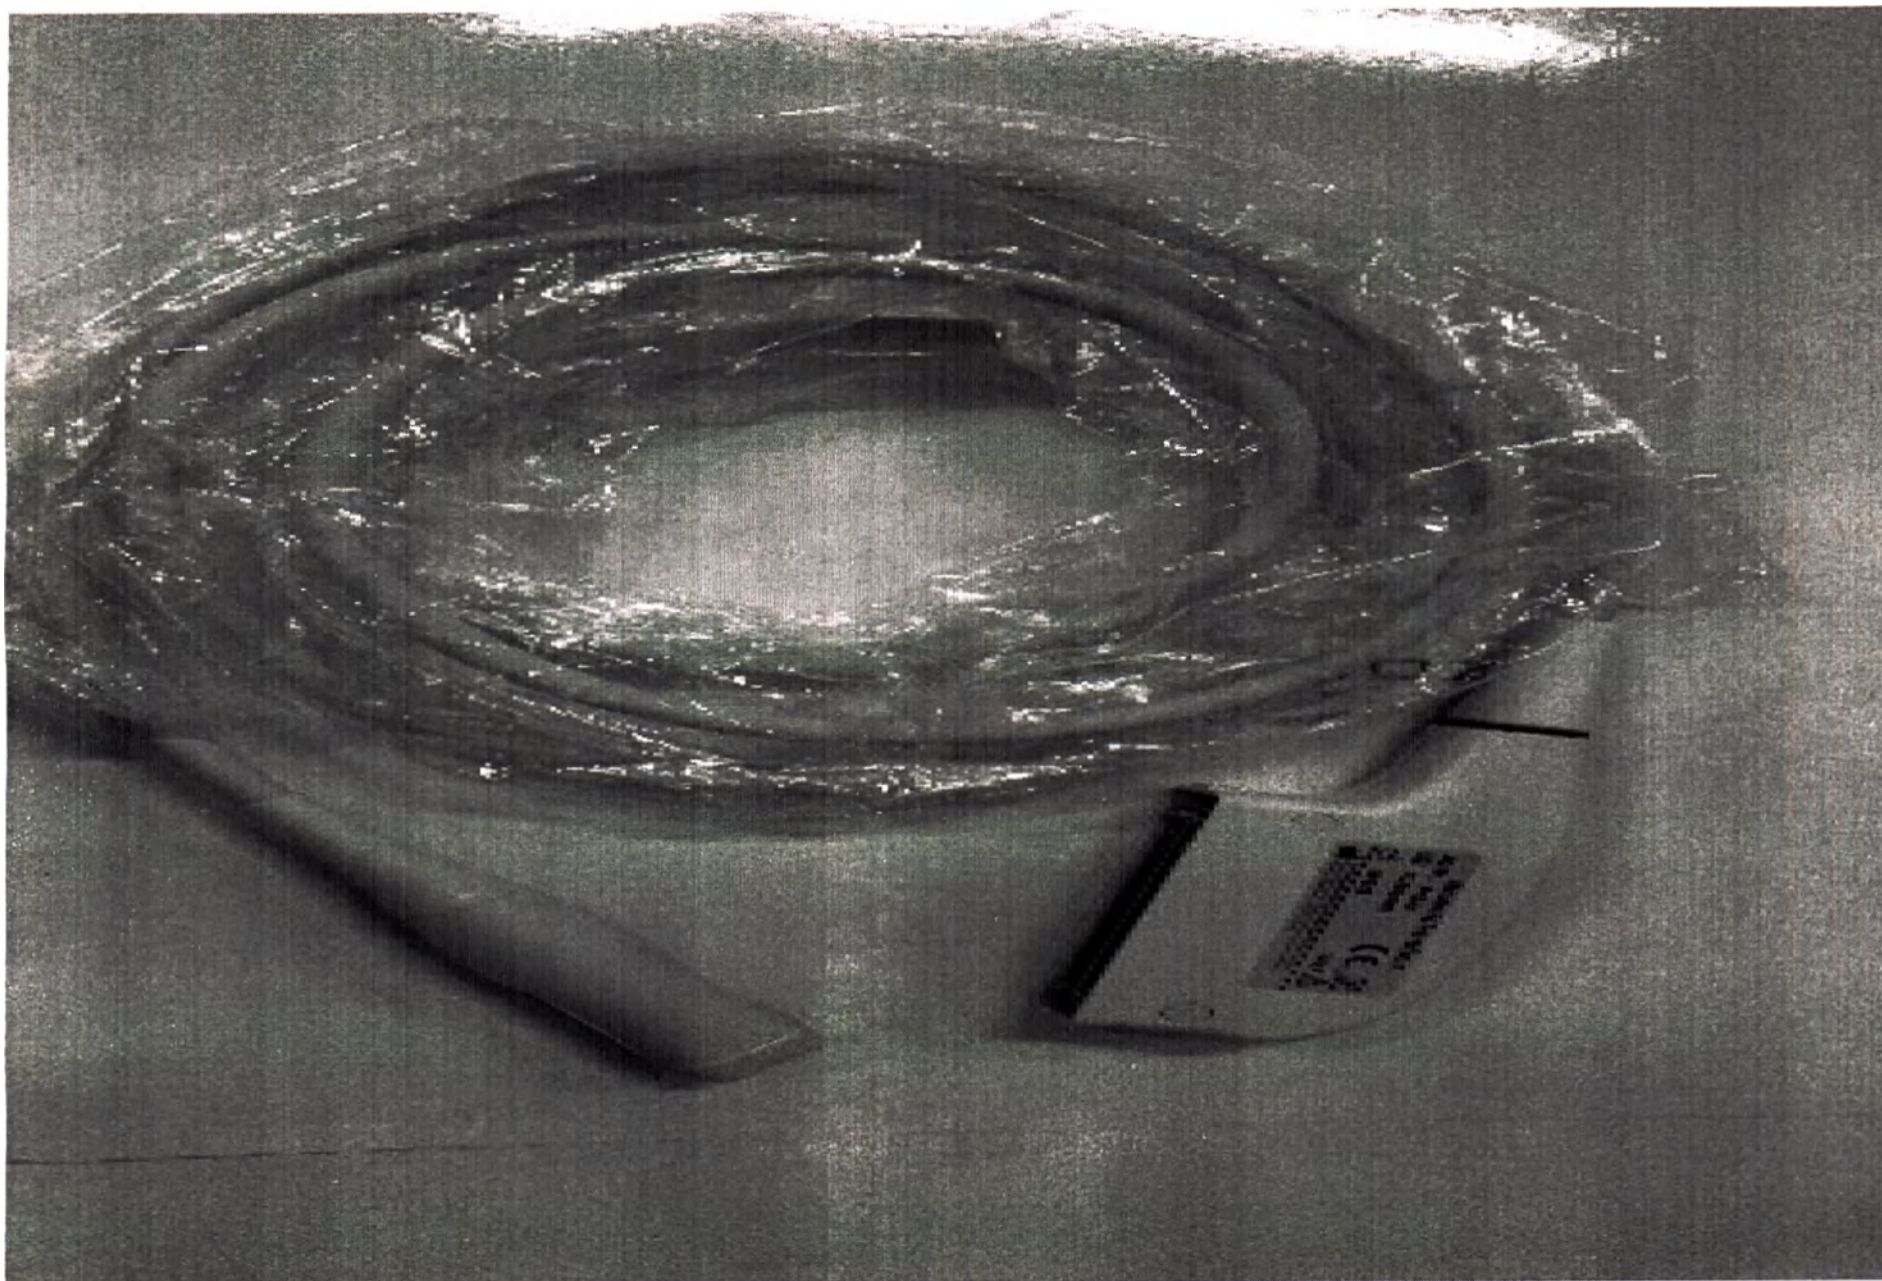




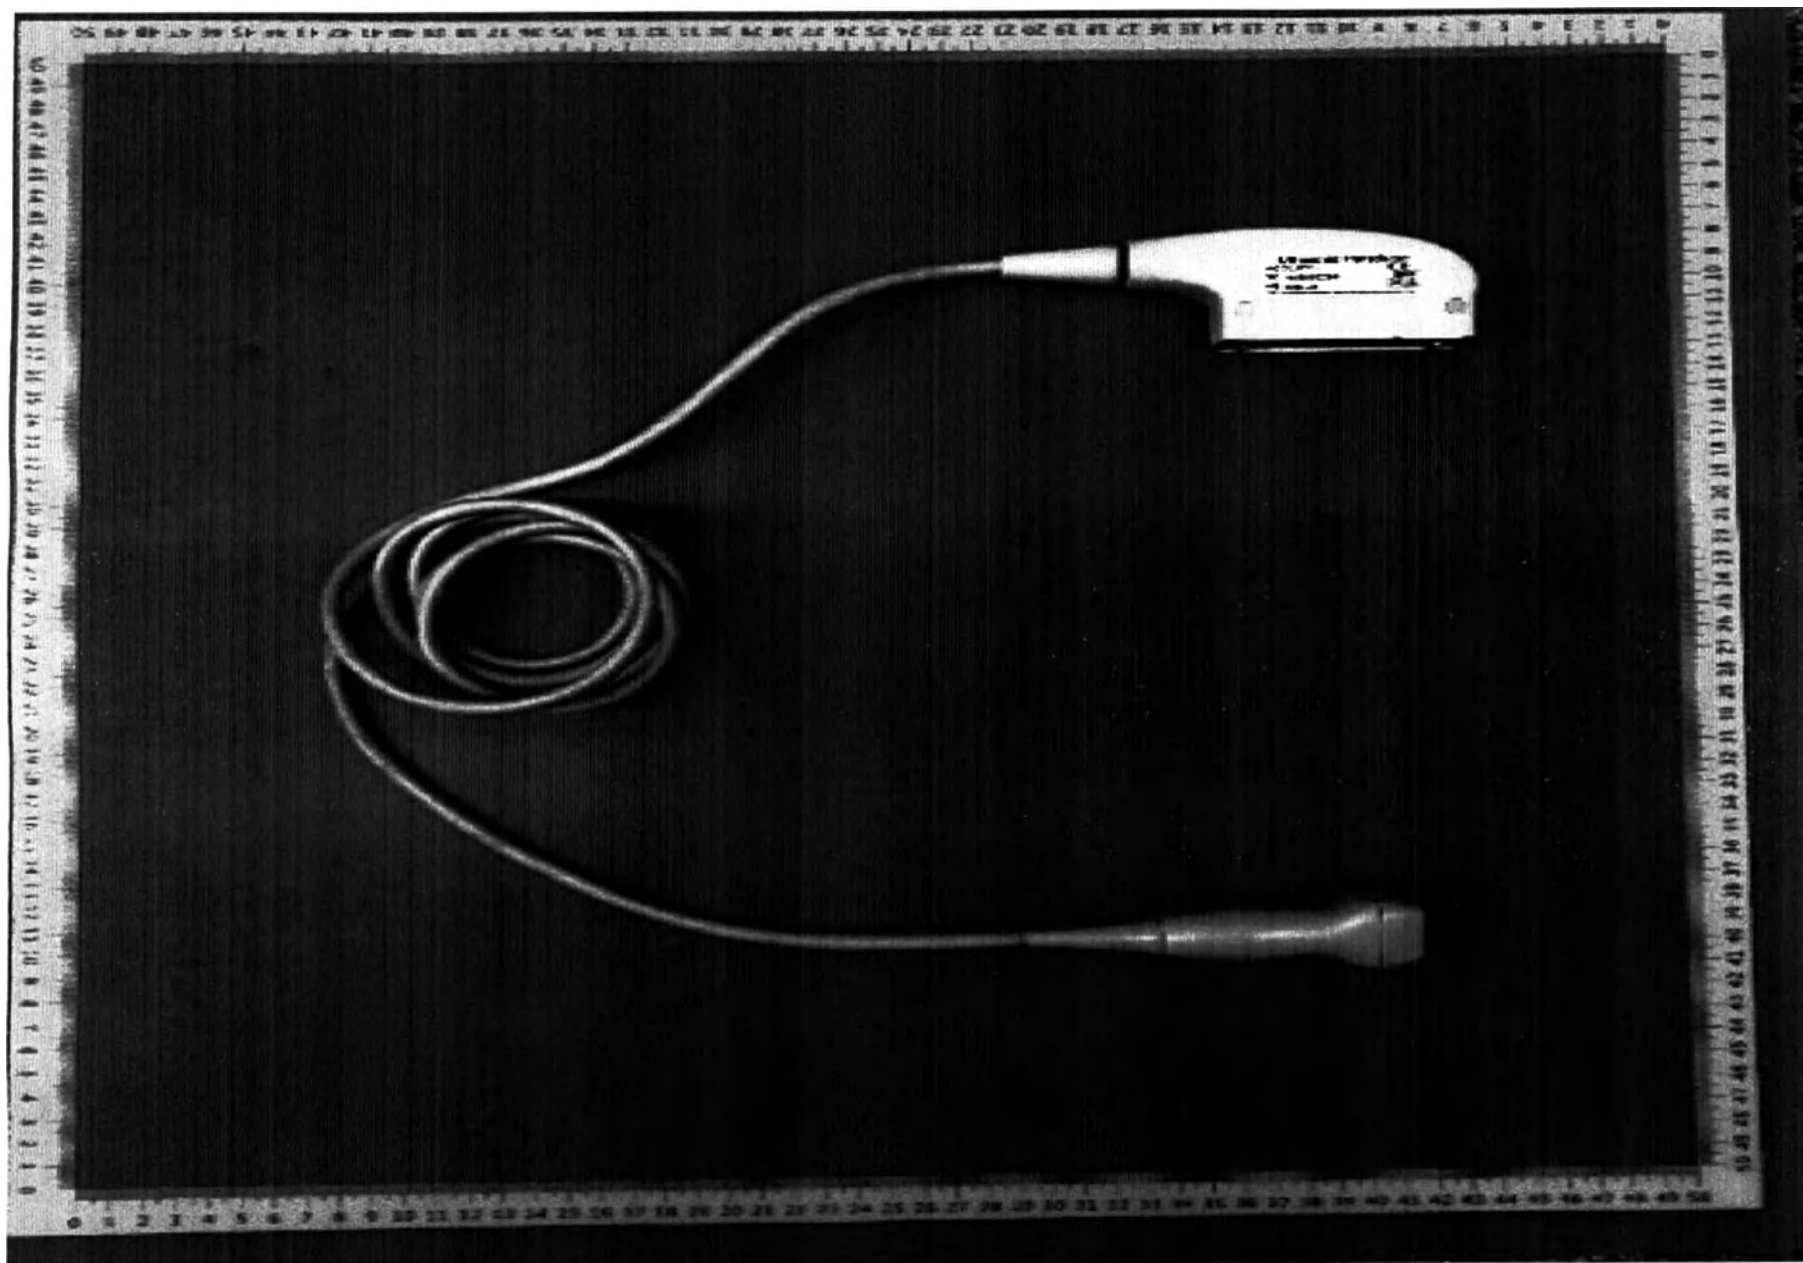



24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный P7-3Ts в составе:

24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

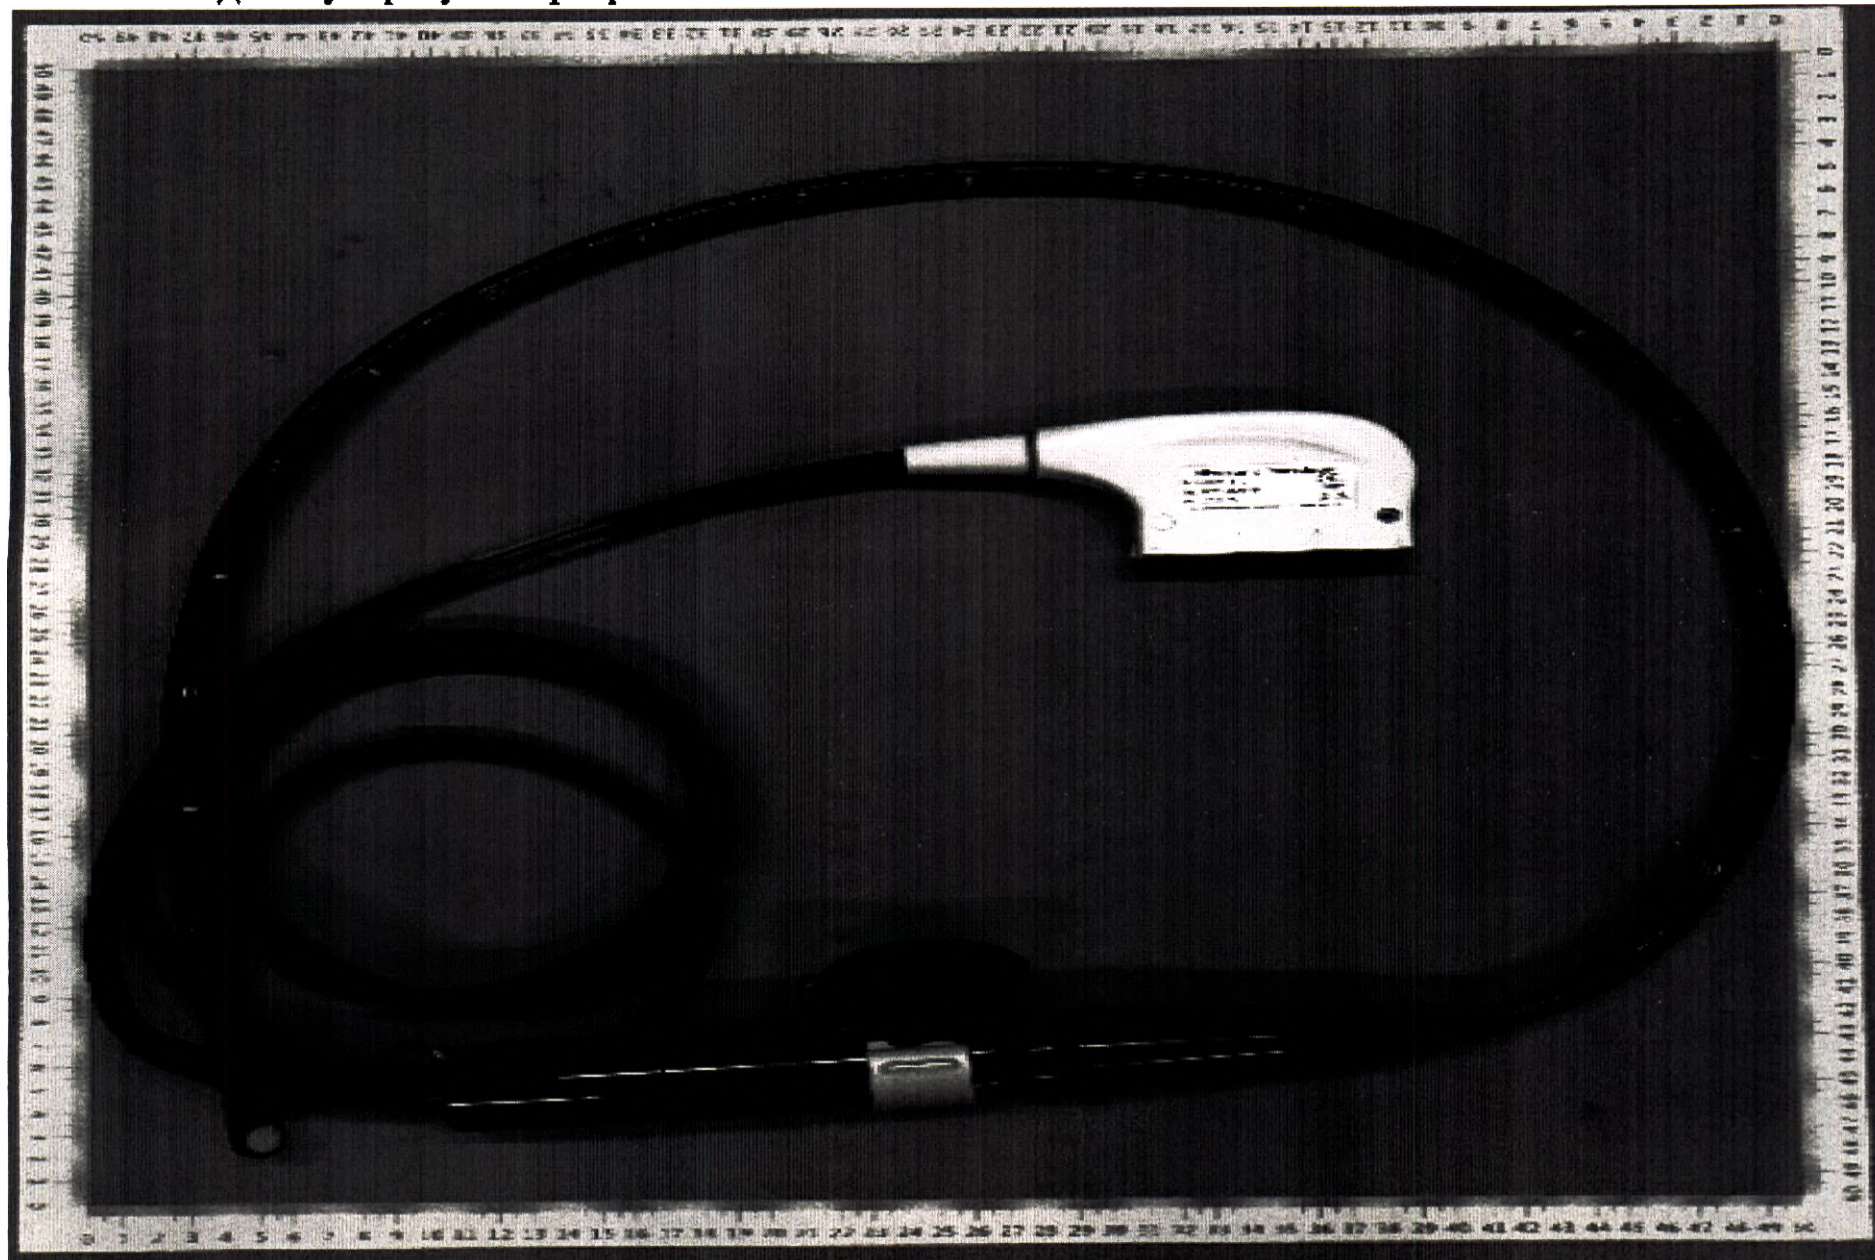



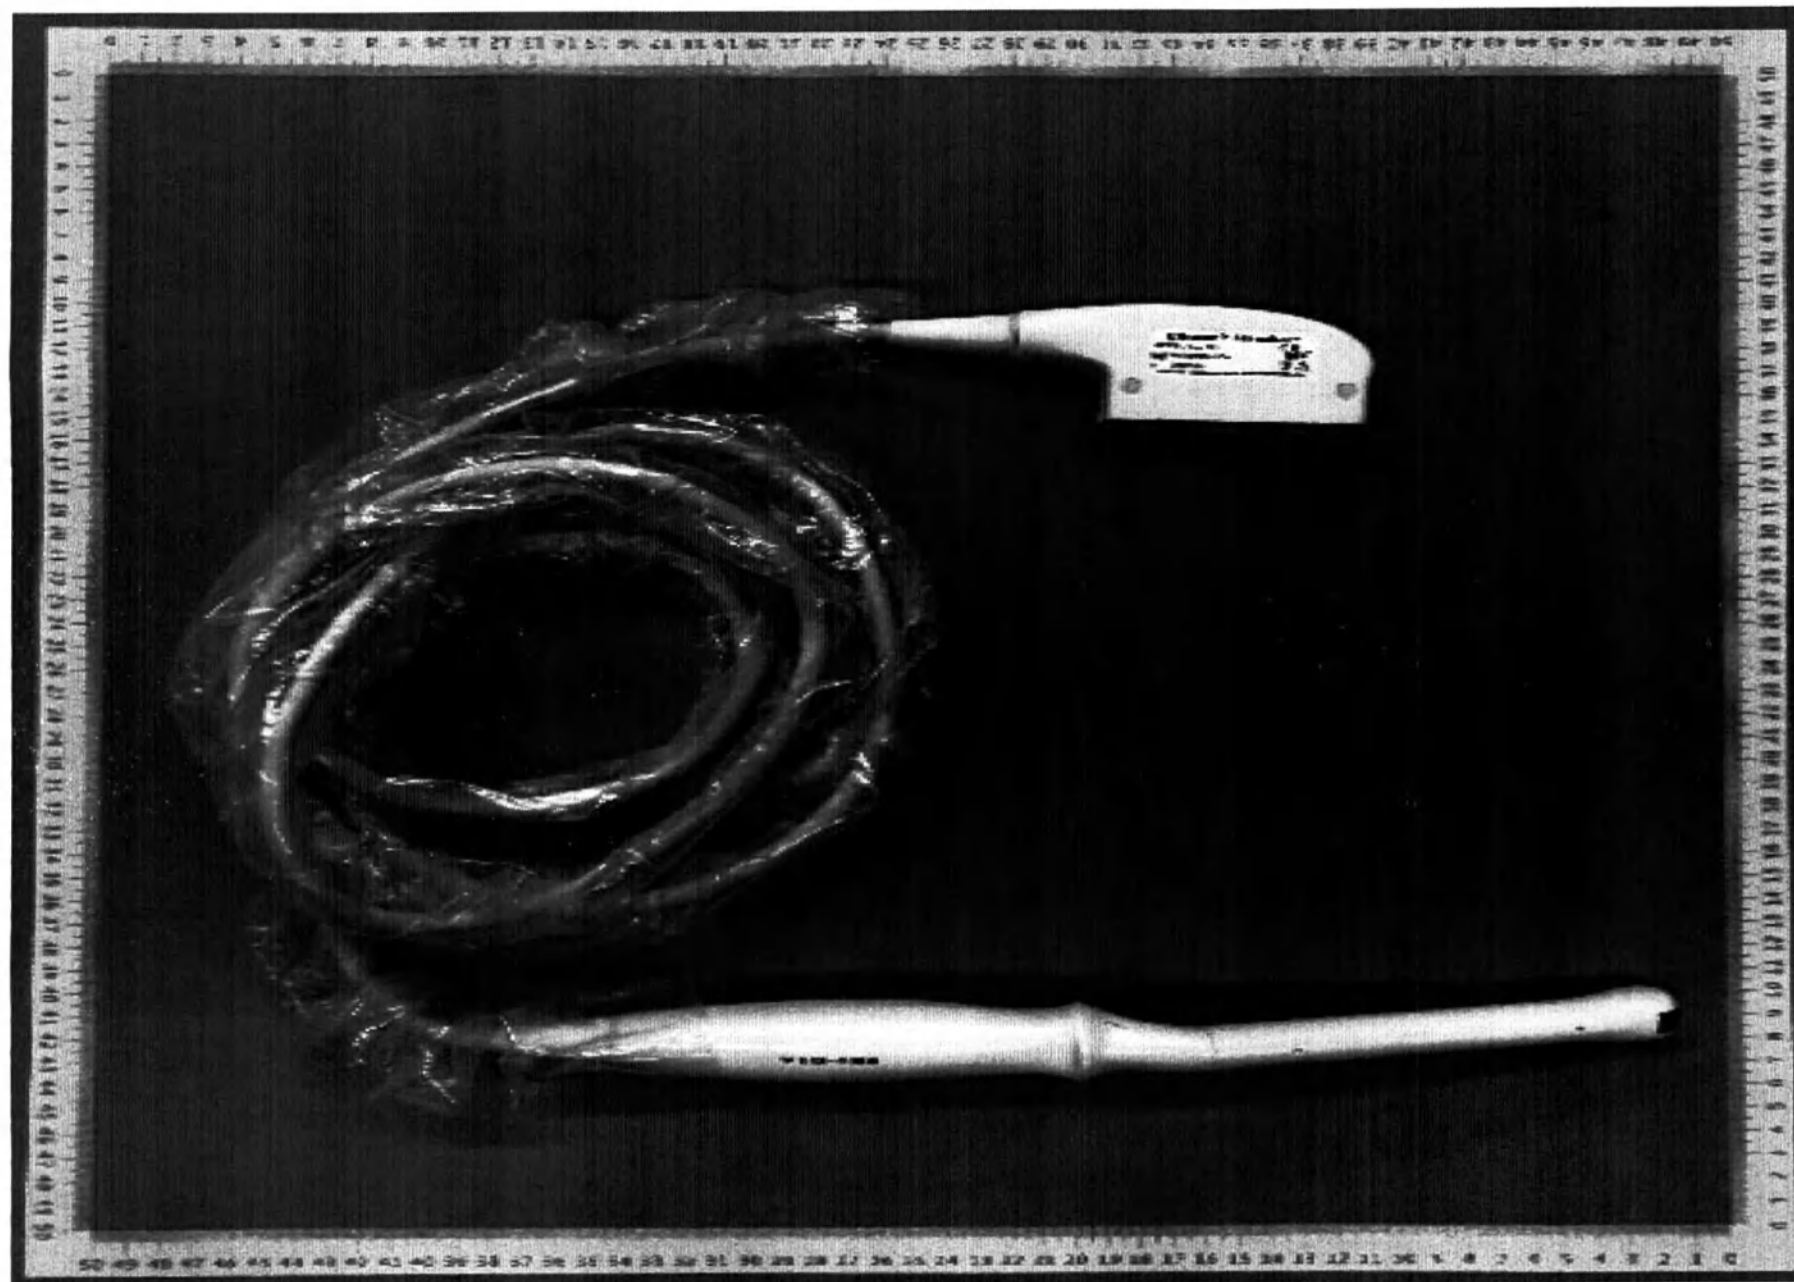

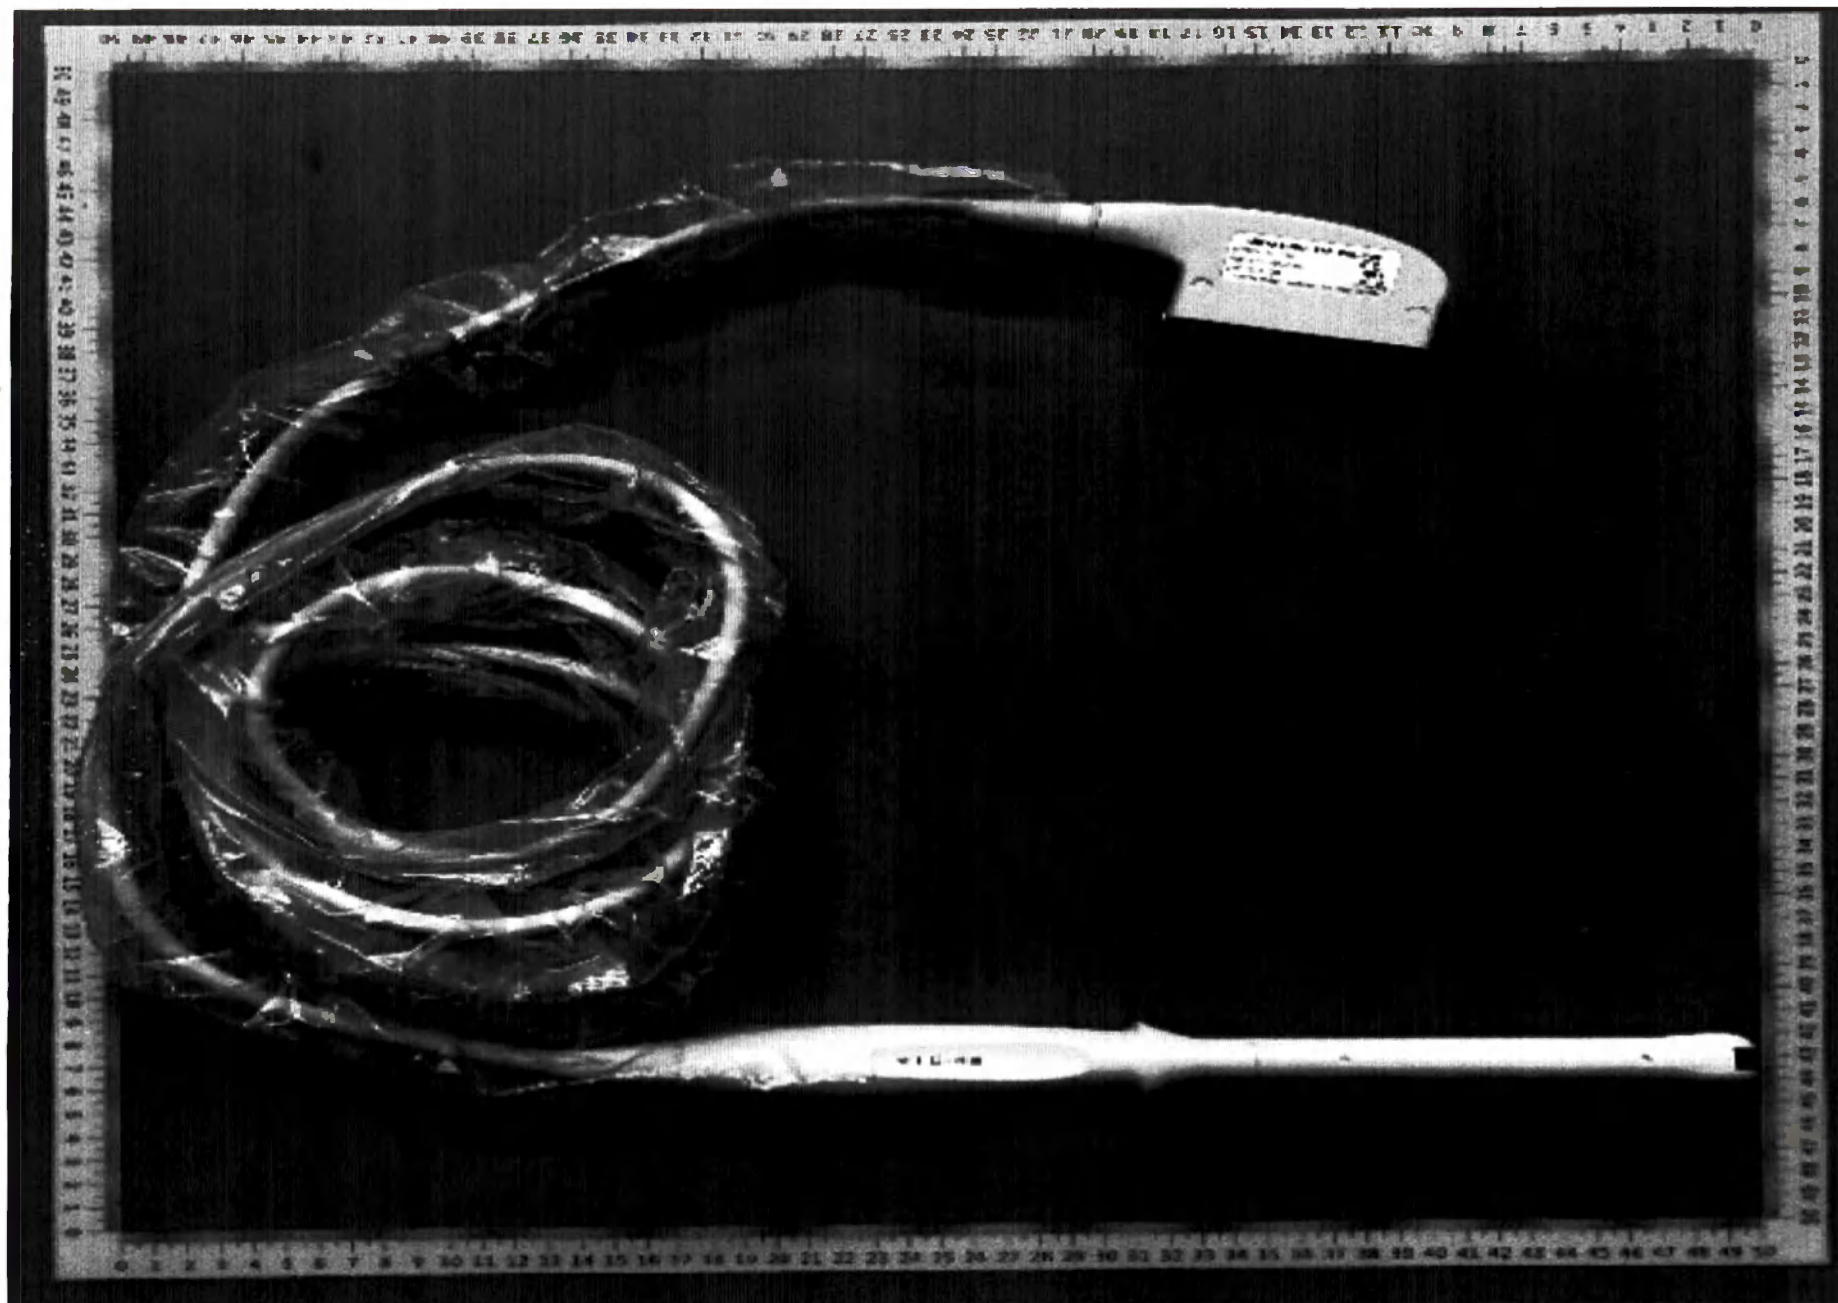


25. Насадки биопсийные, варианты исполнения


25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004





25.2. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-005

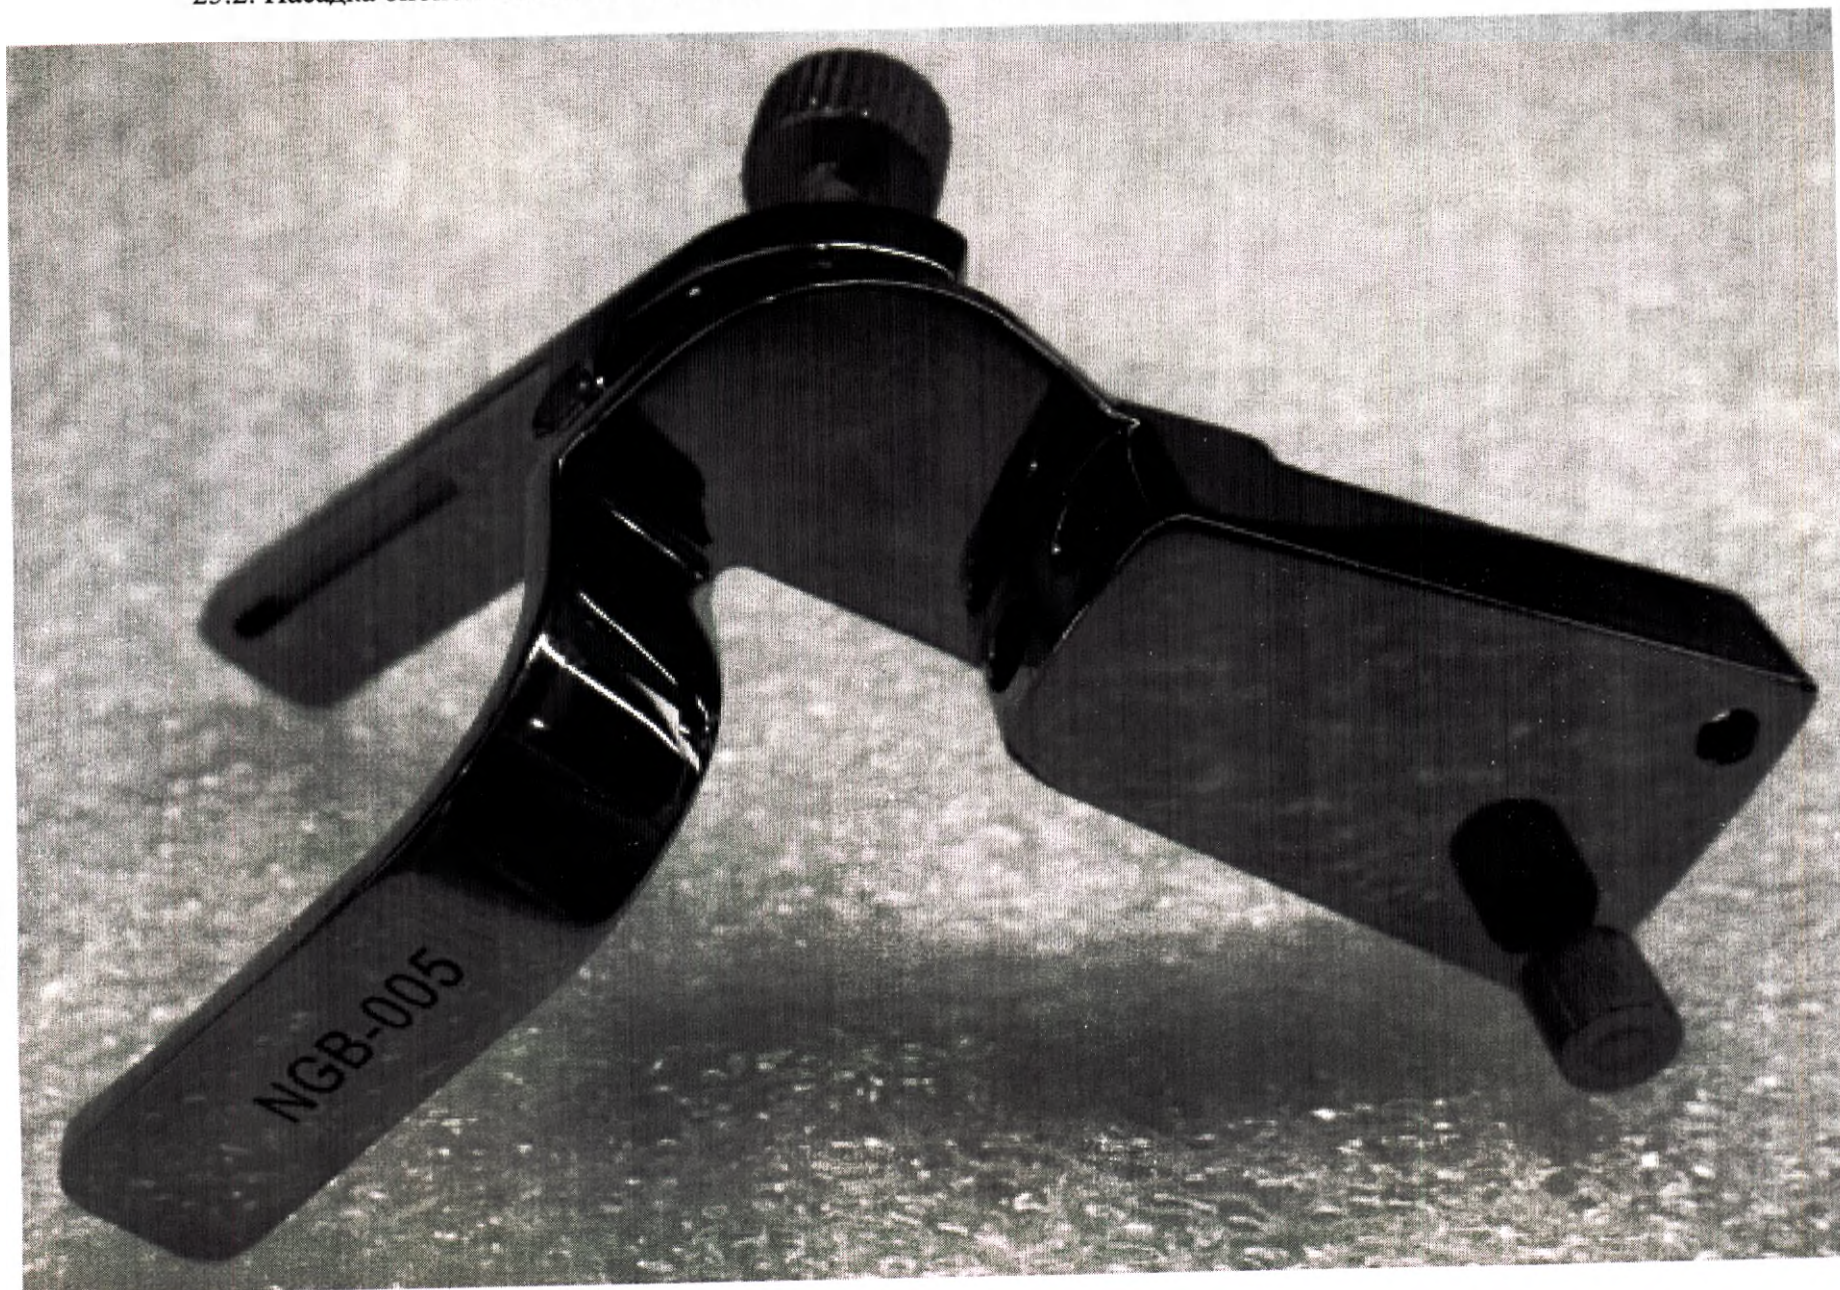




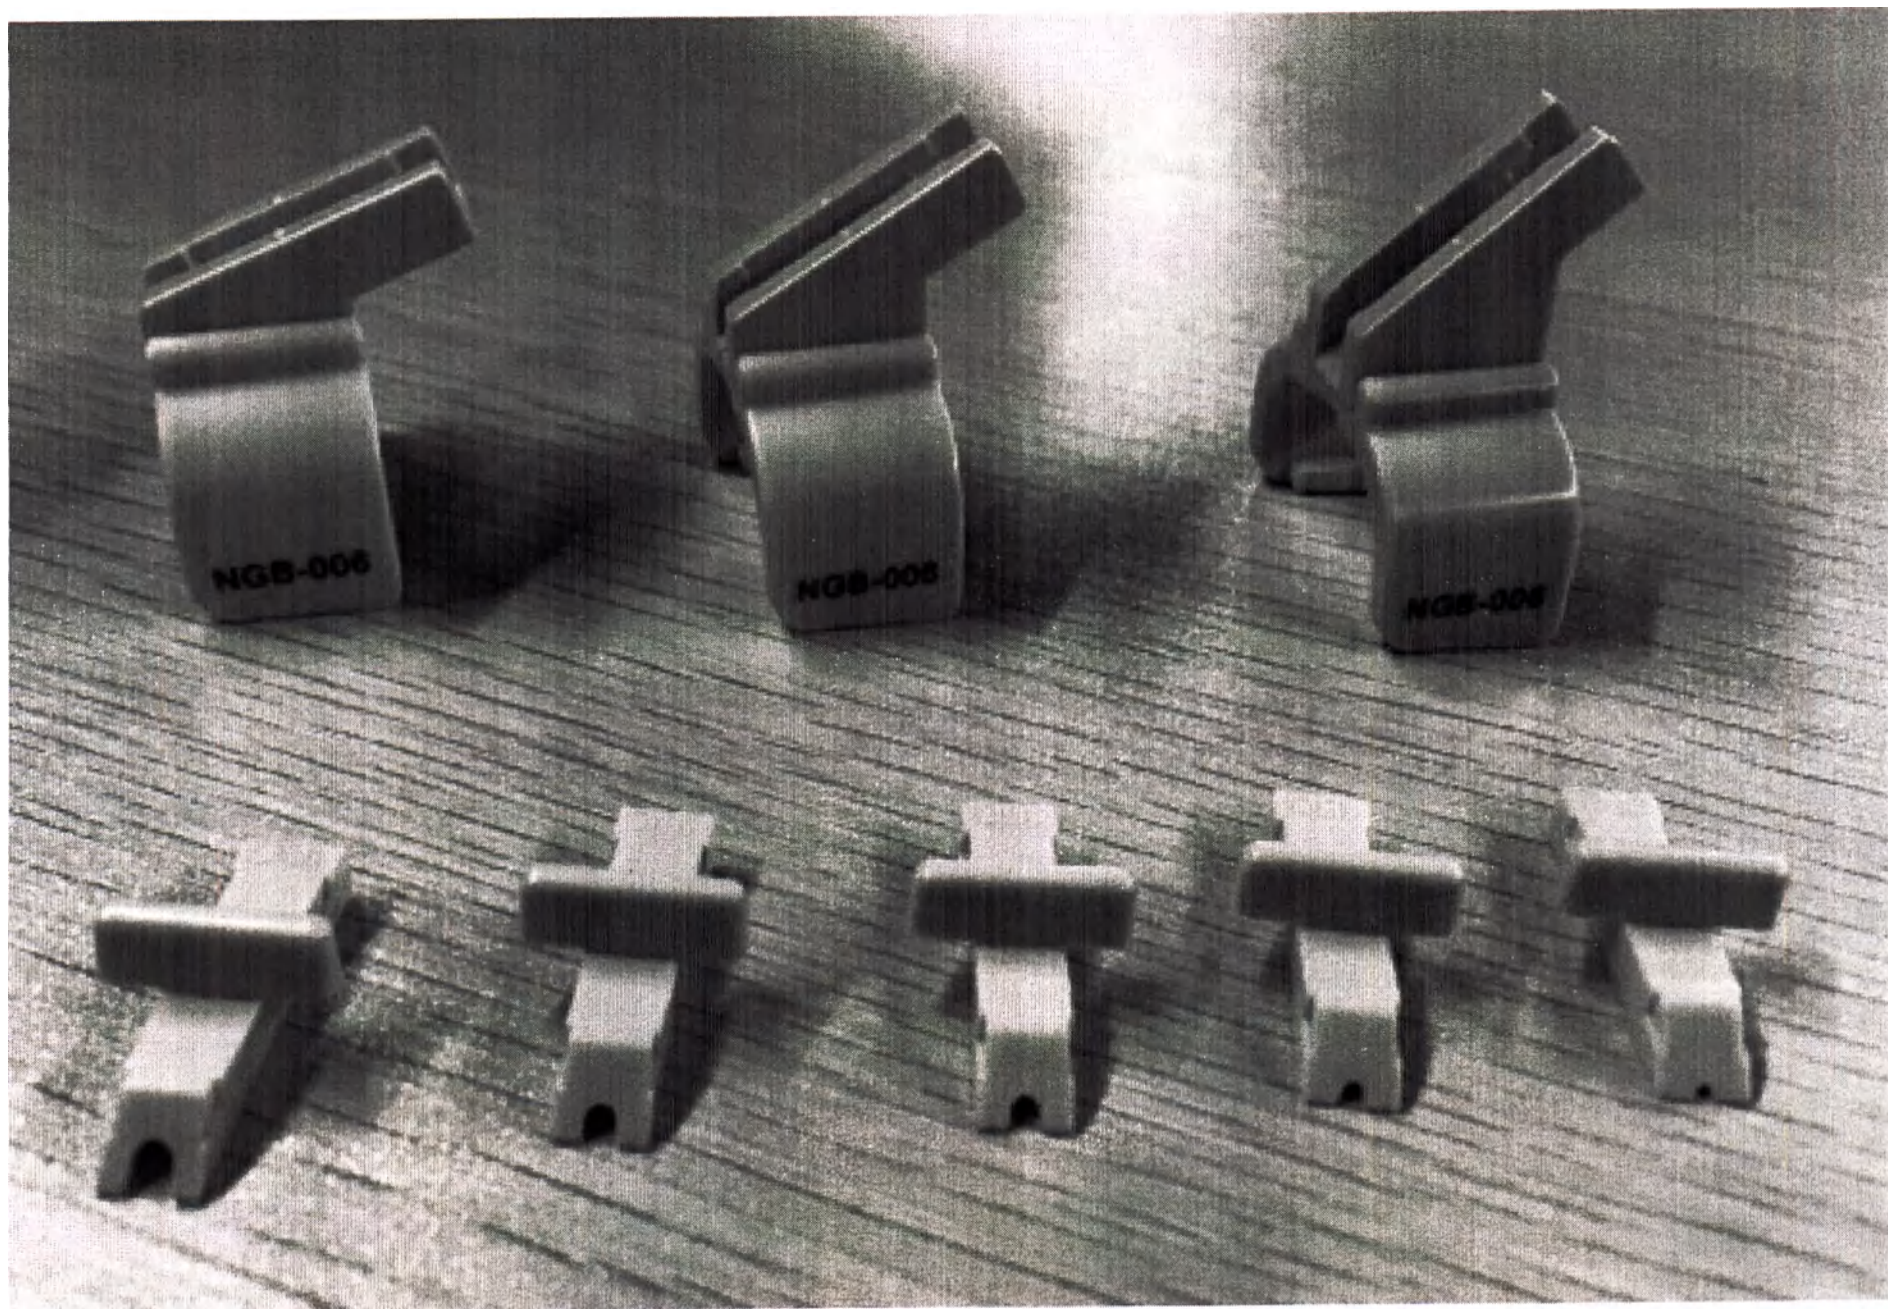


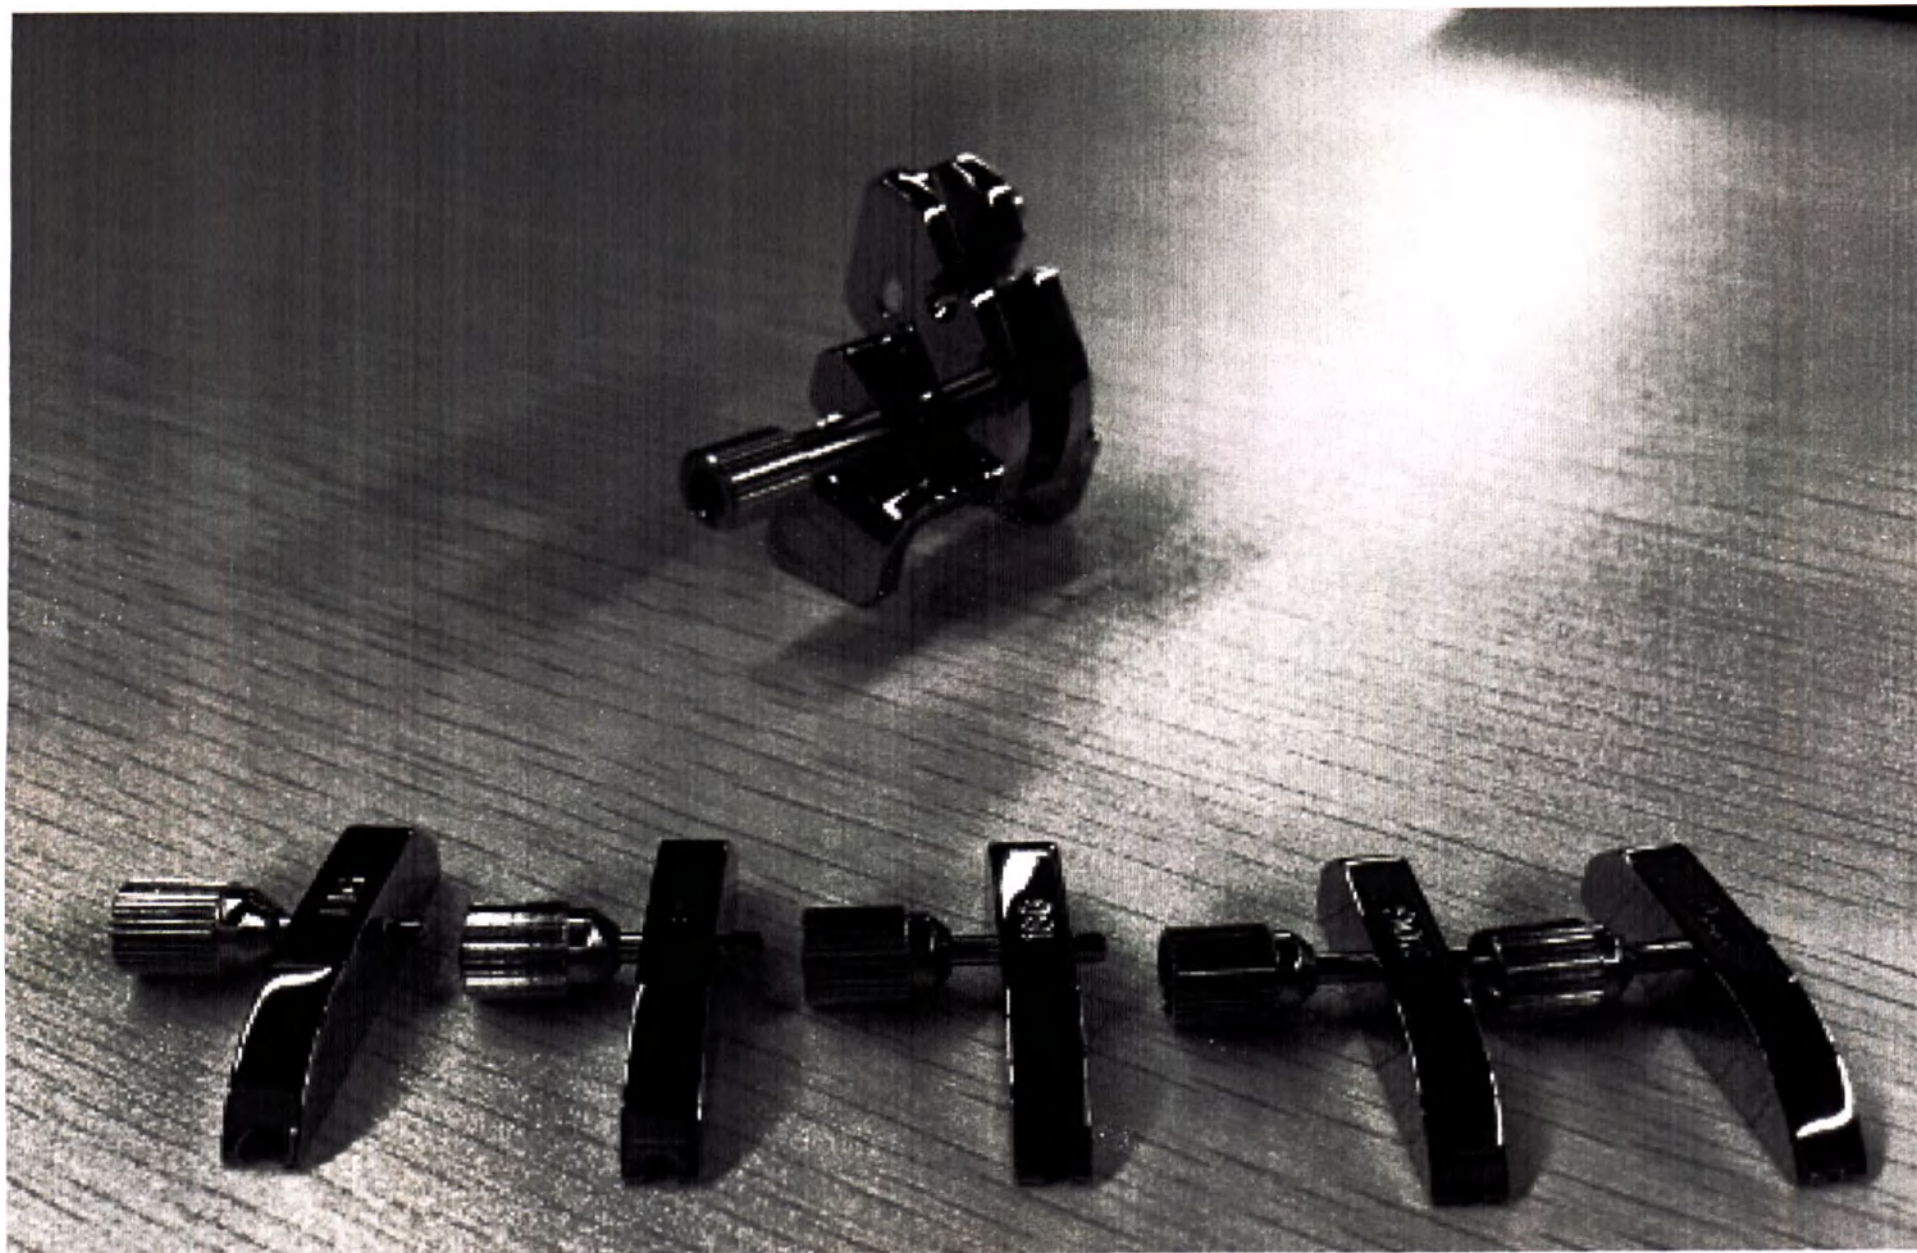

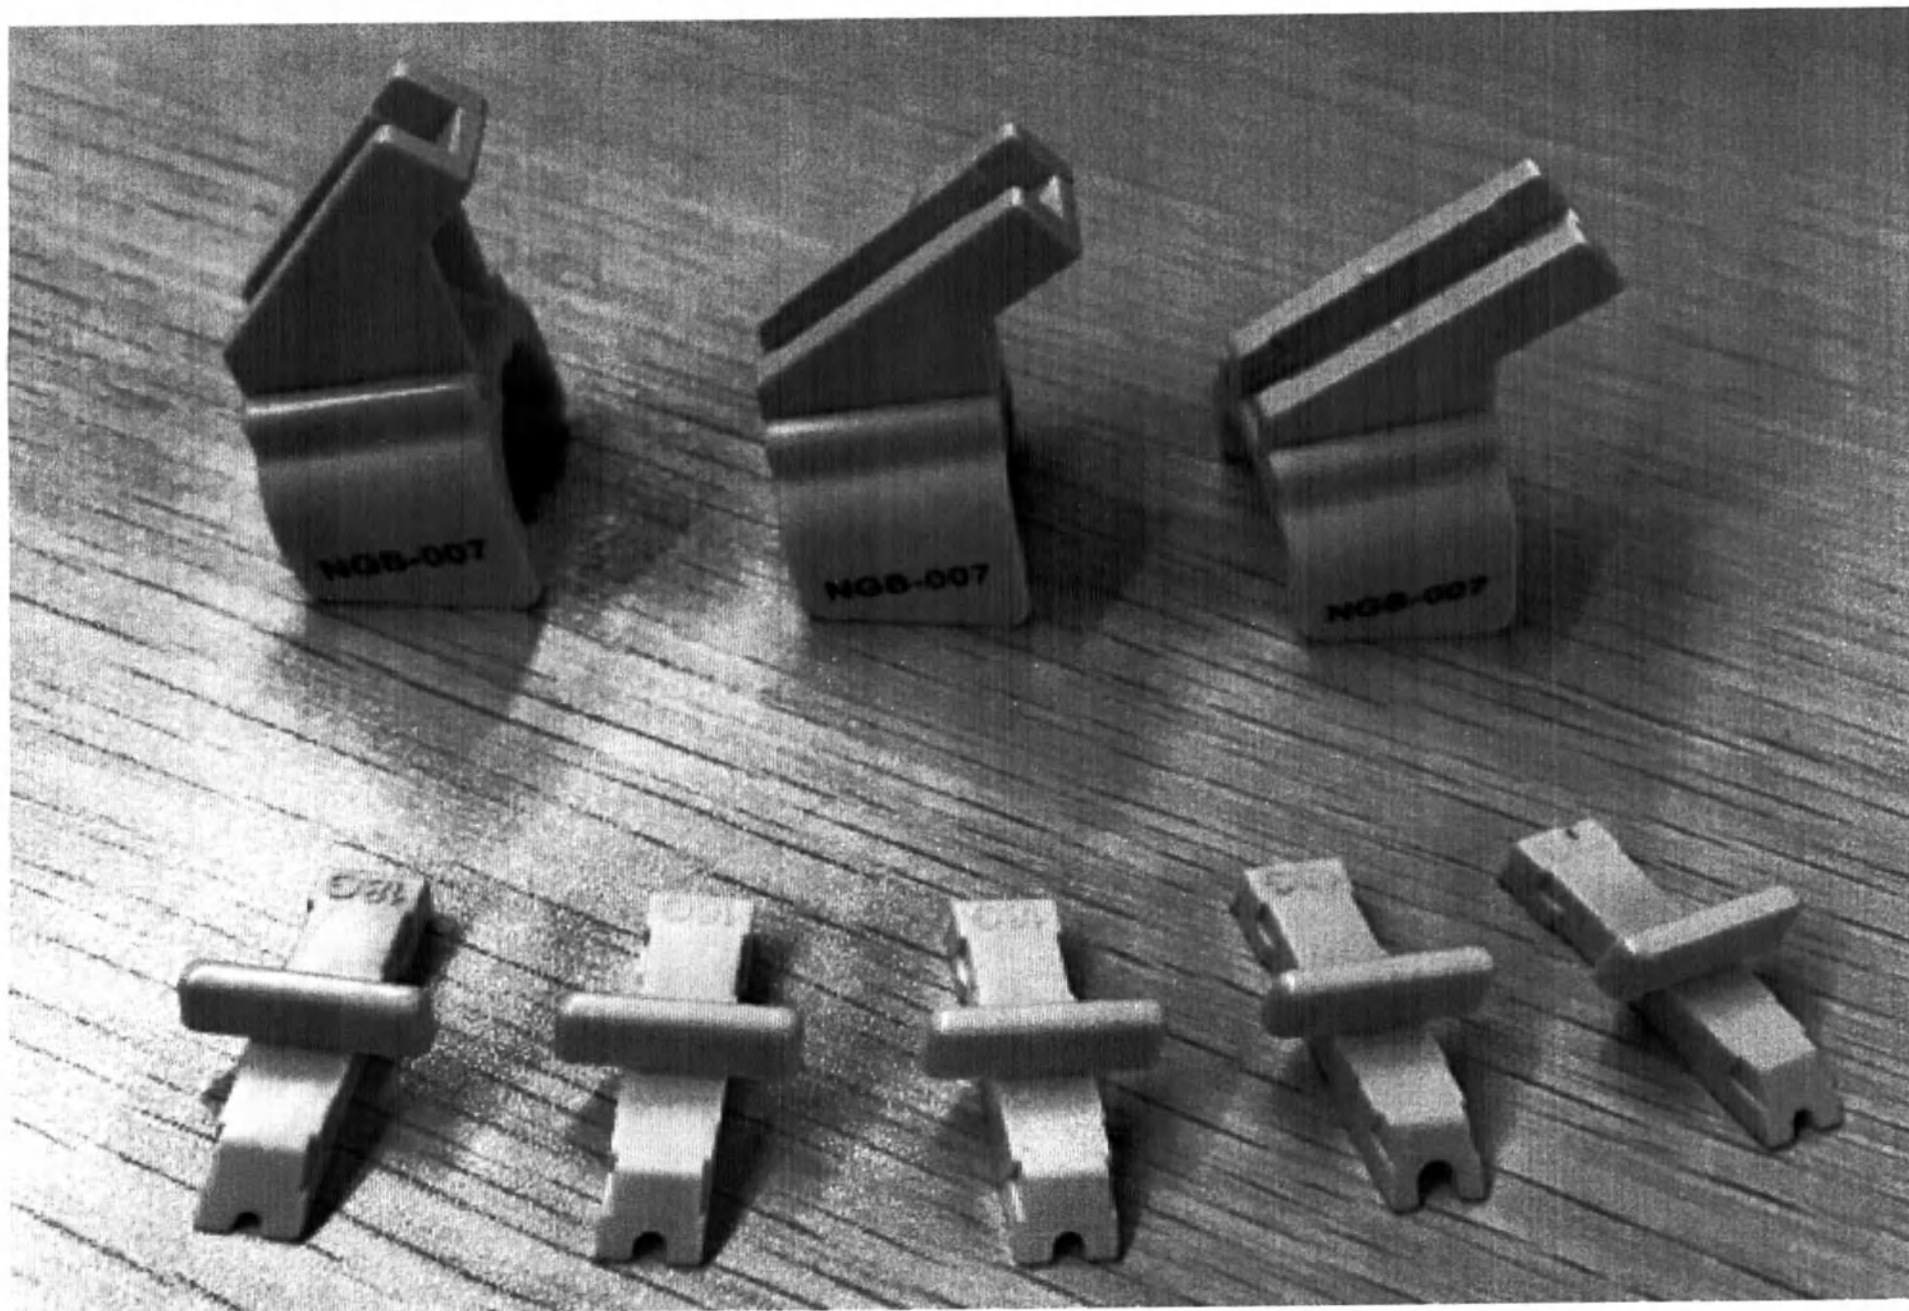




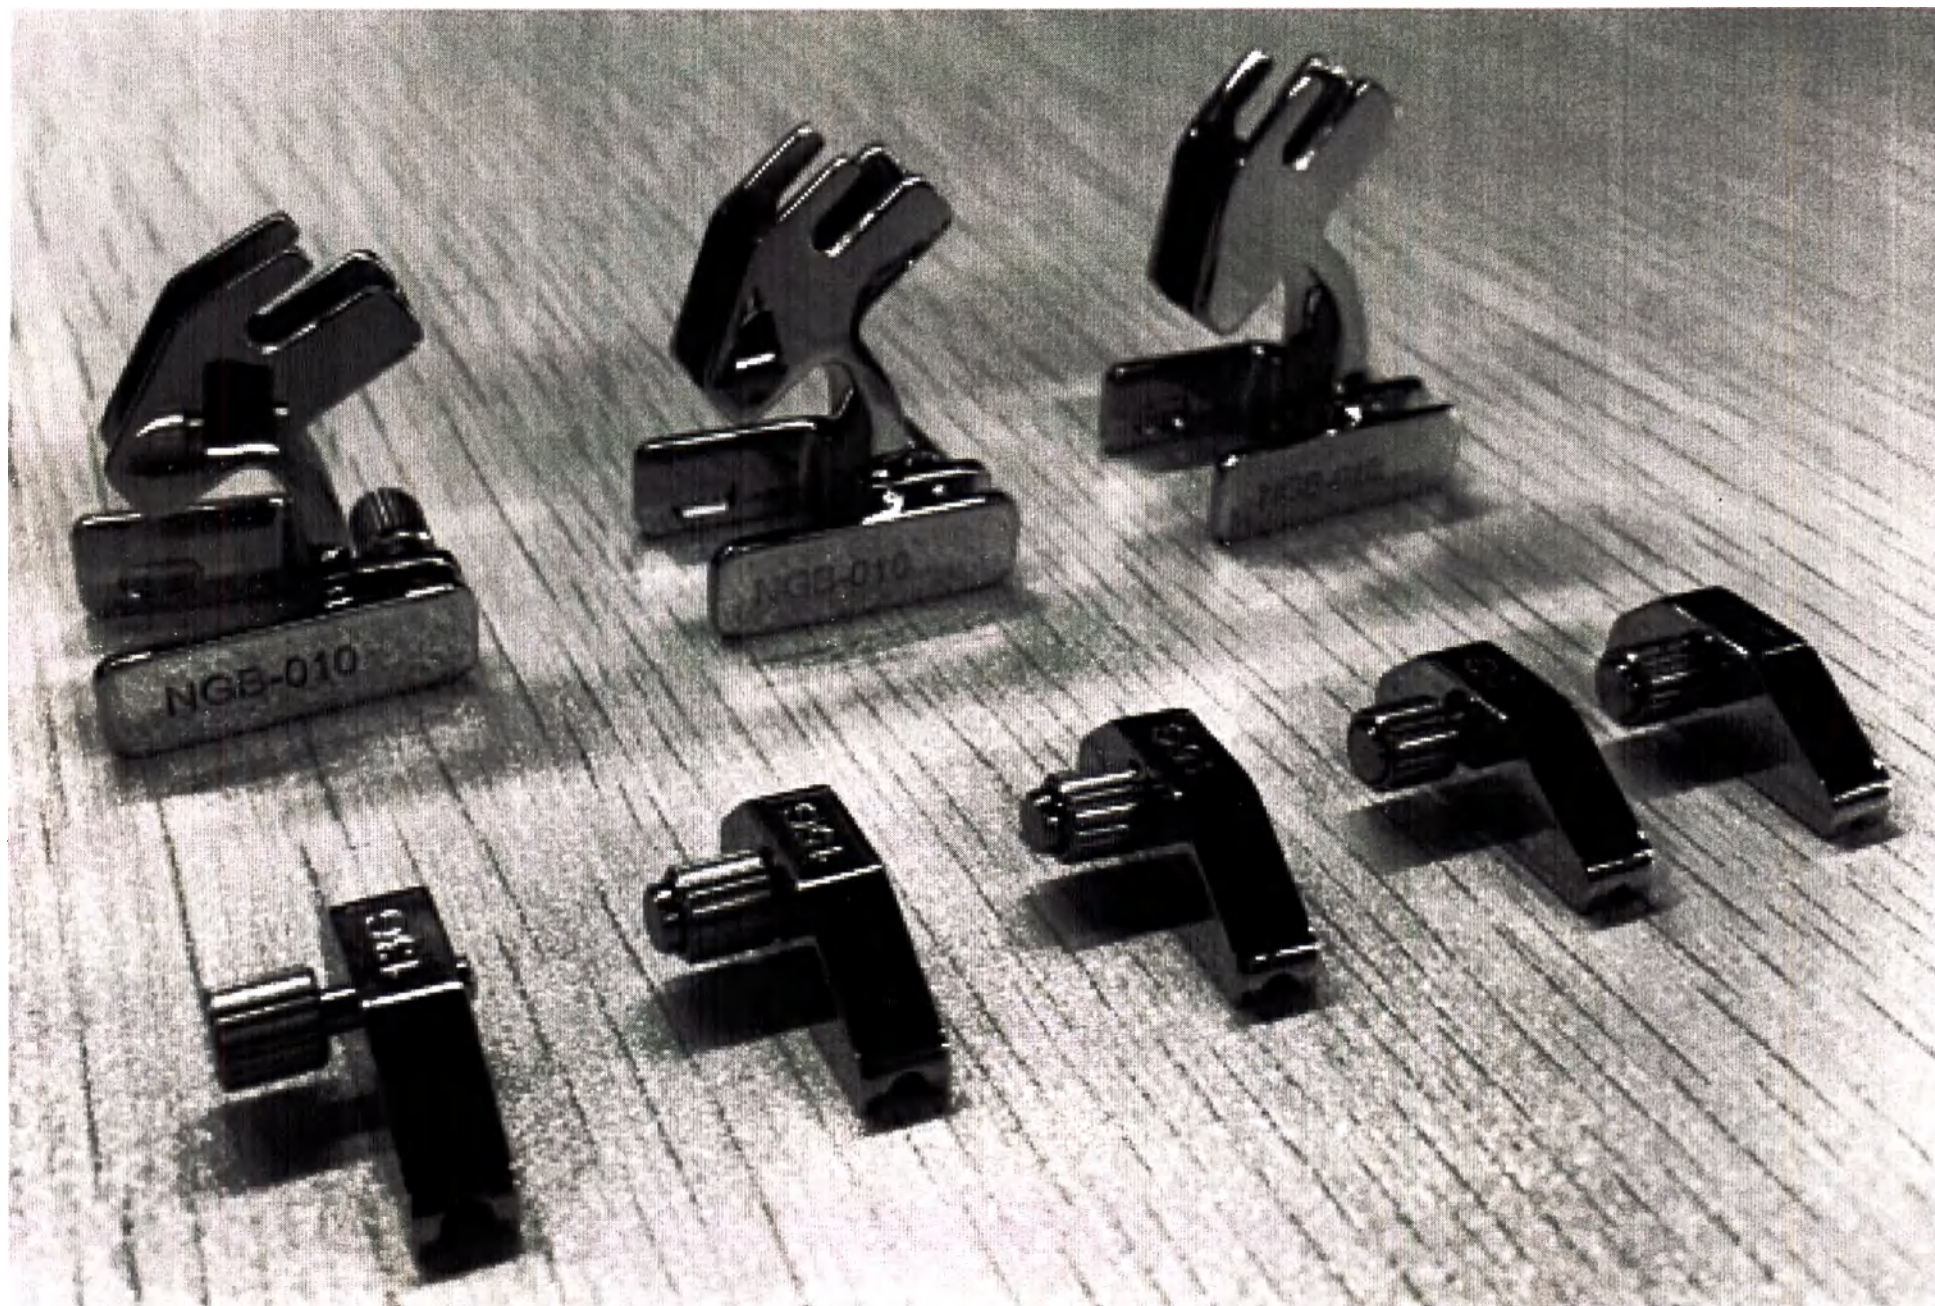

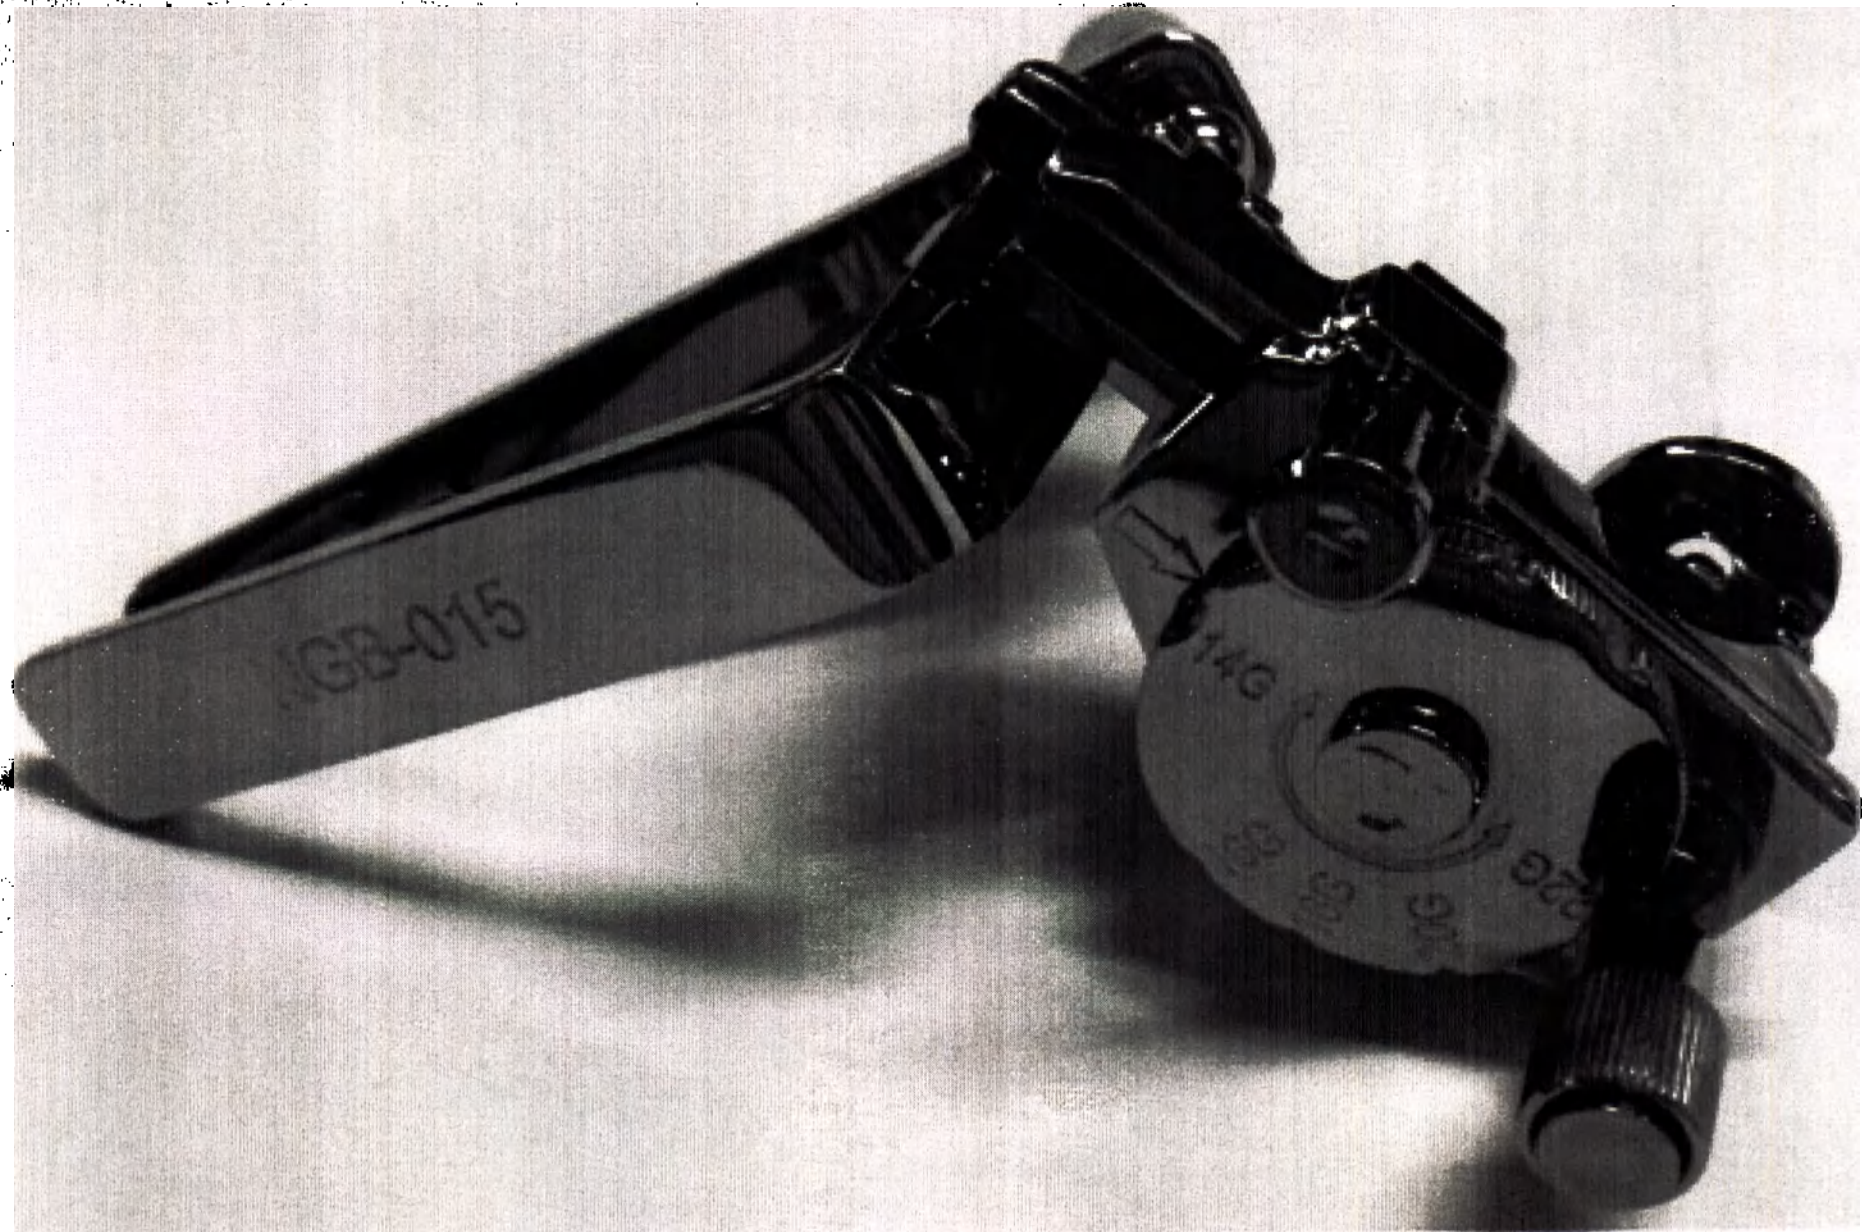


25.10. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-016



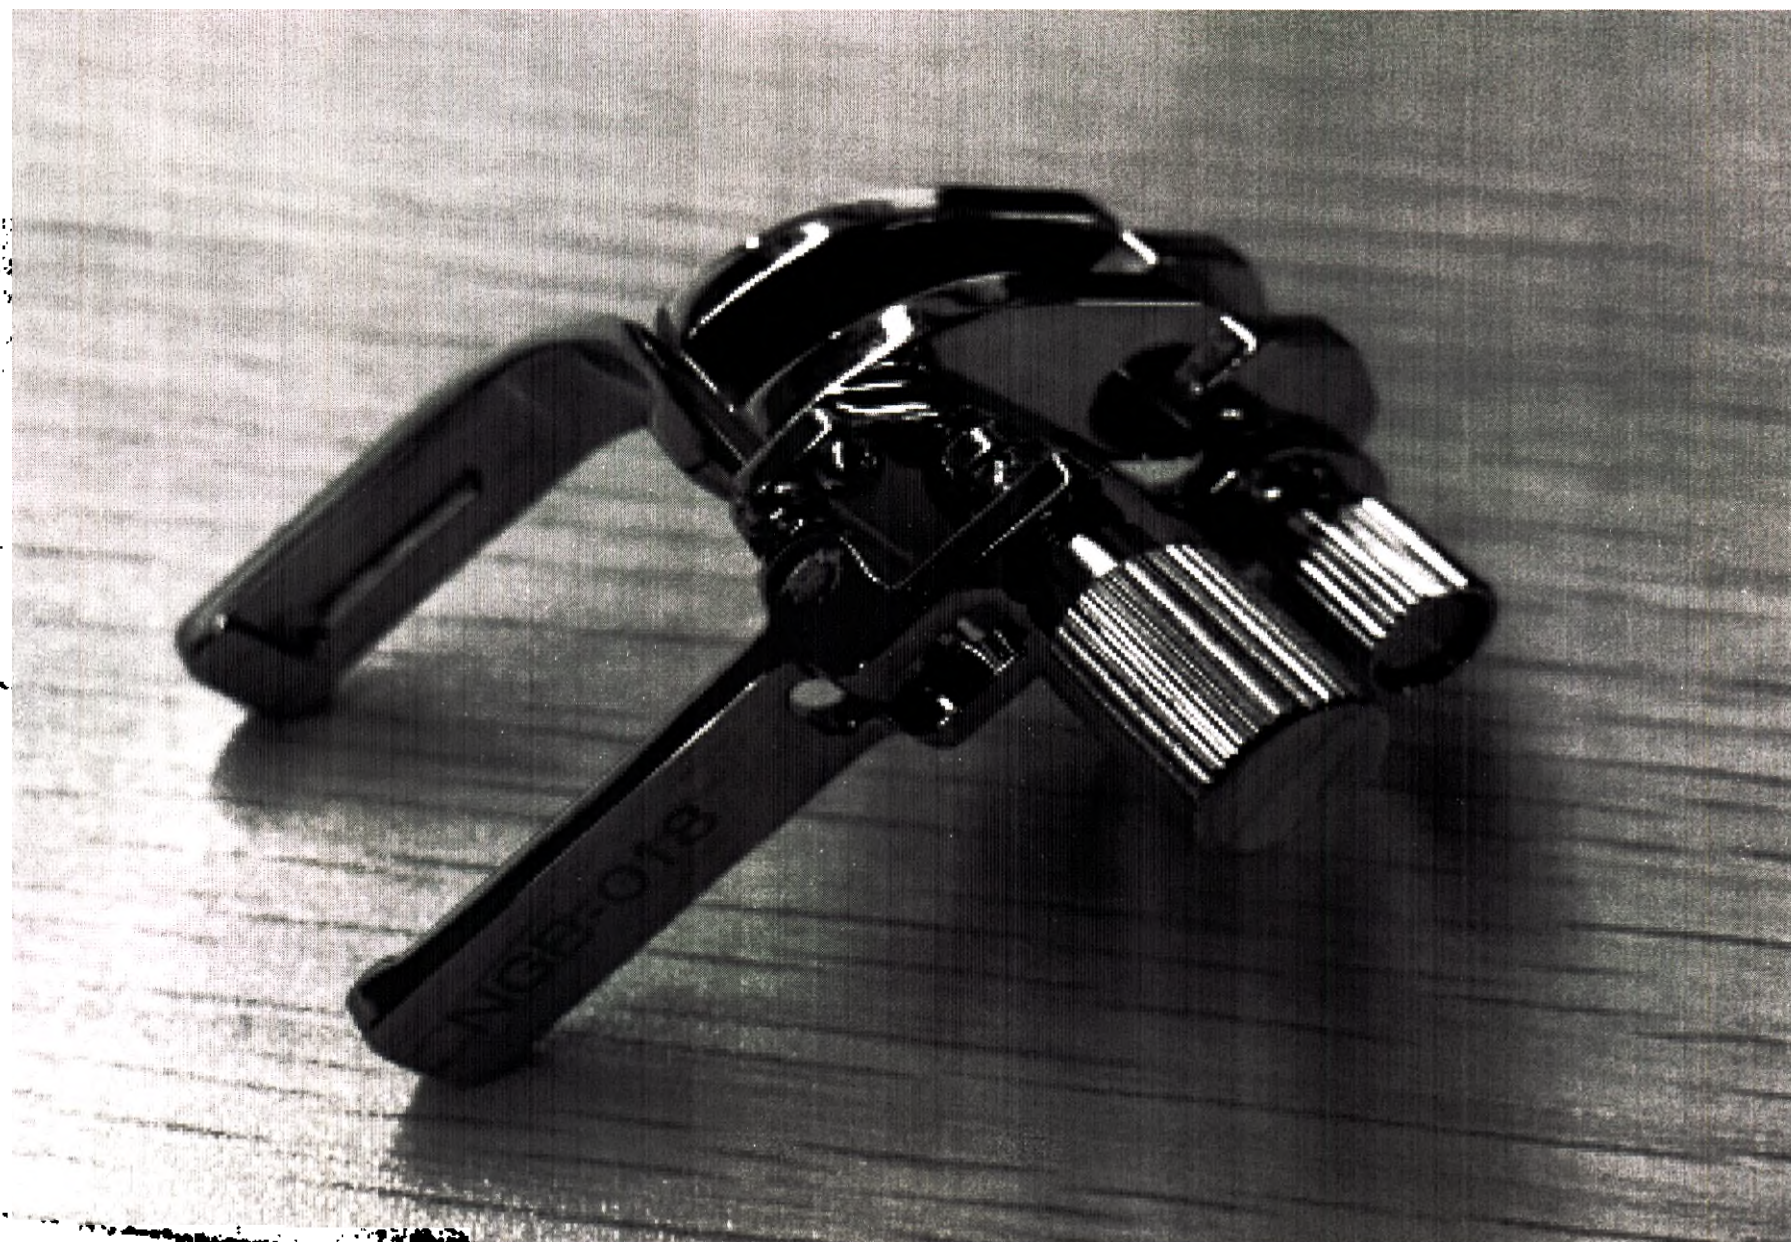

26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)

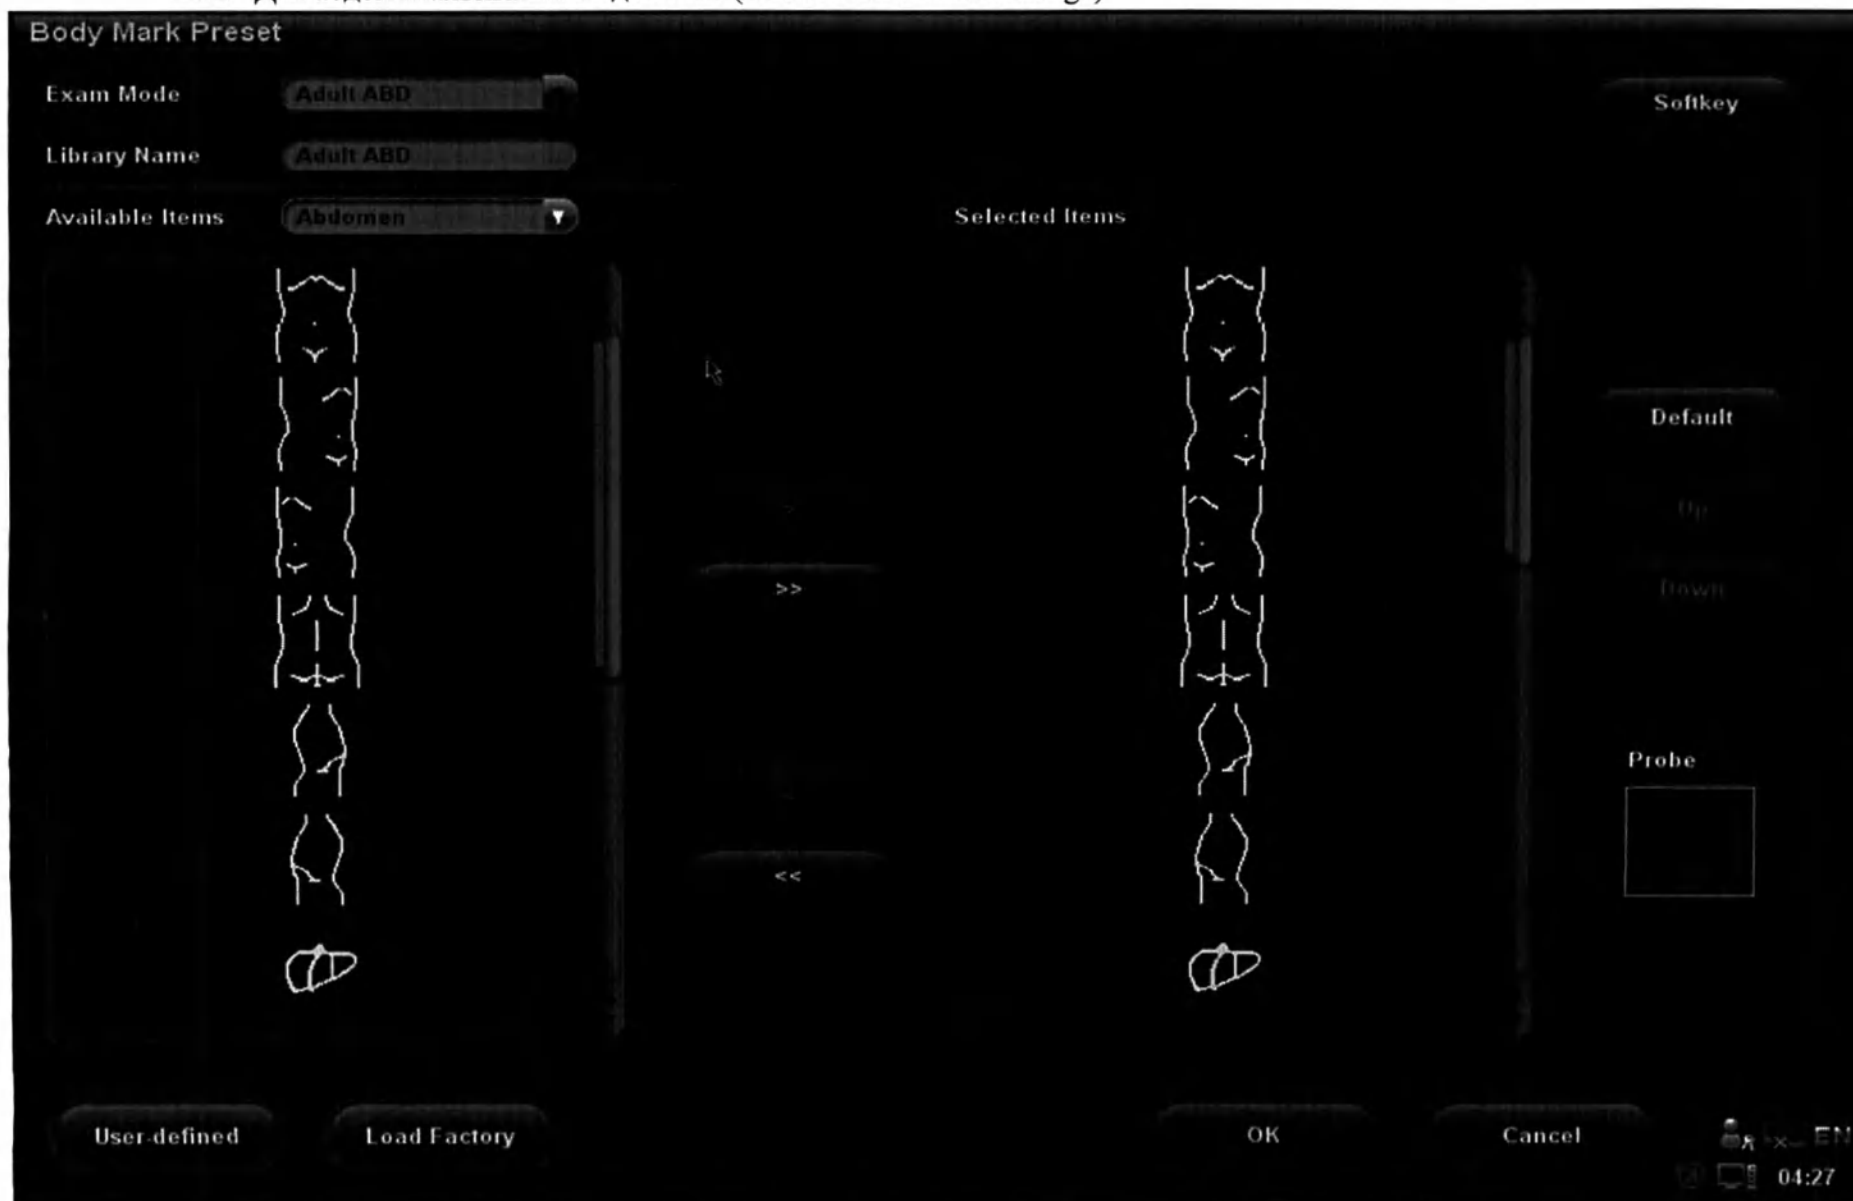

26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)



26.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package)



26.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package)

Body Mark Preset

Exam Mode

GYN

Library Name

GYN

Available Items

GYN

Selected Items









>>

<<









Softkey

Default

Probe



User-defined

Load Factory


OK

Cancel



04:26

26.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package)

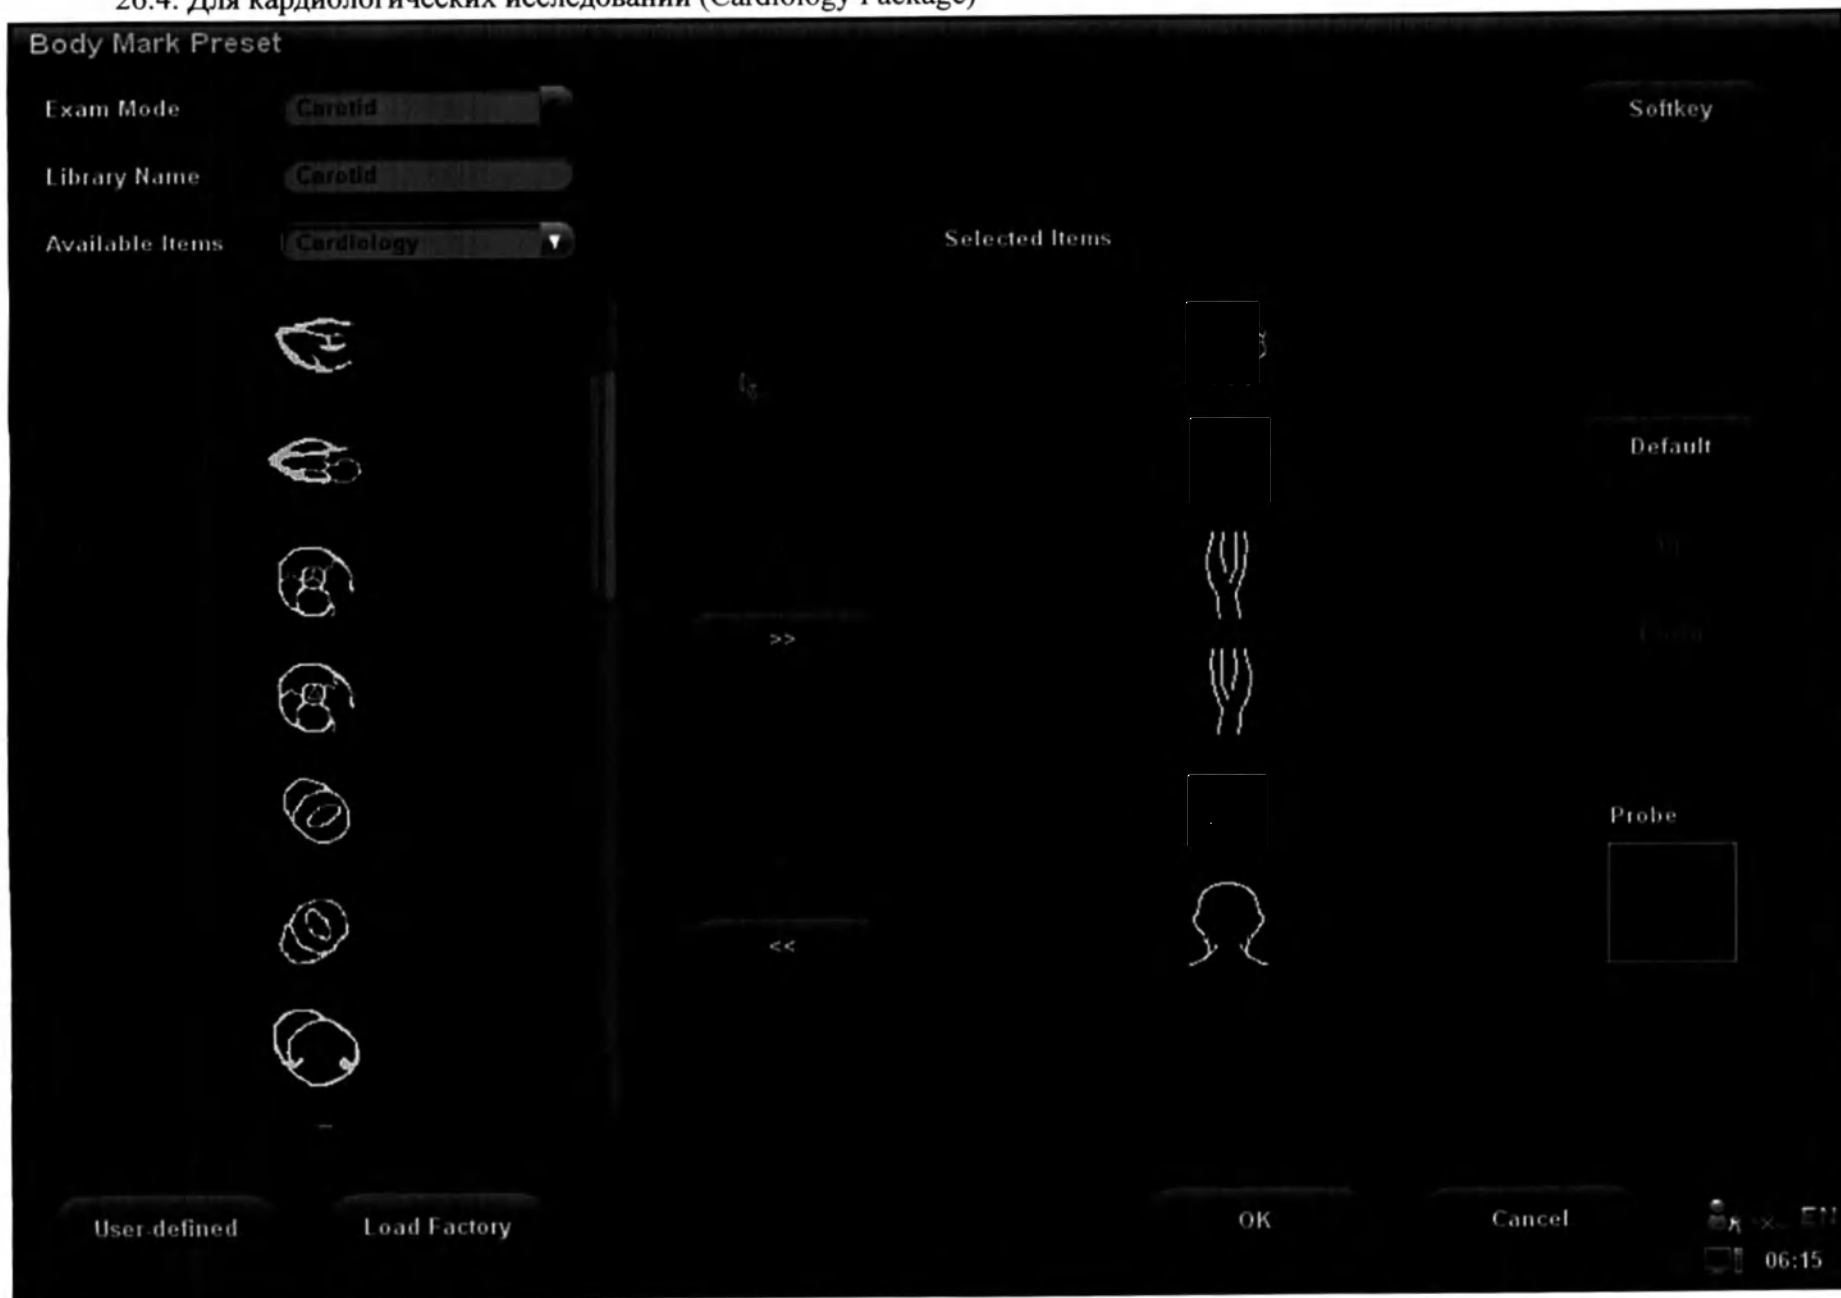

26.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package)

Body Mark Project

Exam Mode Settings

Library Name

Available Items	Selected Items
	
	
	
	
	
	
	
	

Default

Probe

User defined Load Factory

OK Cancel

06:15

26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

Body Mark Preset

Team Mode

▼

Softkey

Library Name

Available Item

Selected Items









OK

Cancel

Default

Probe

Item defined

Load Factory

OK

Cancel

04/20

26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)

Body Mark Preset

Exam Mode

Softcopy

Library Name

Available Items

Selected Item



Default

Probe

Use as default

Load Factory

OK

Cancel

06.10.2023

26.8. Для исследований в педиатрии (Pediatrics Package)



26.9. Для исследований нервов (Nerve Package)








26.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)






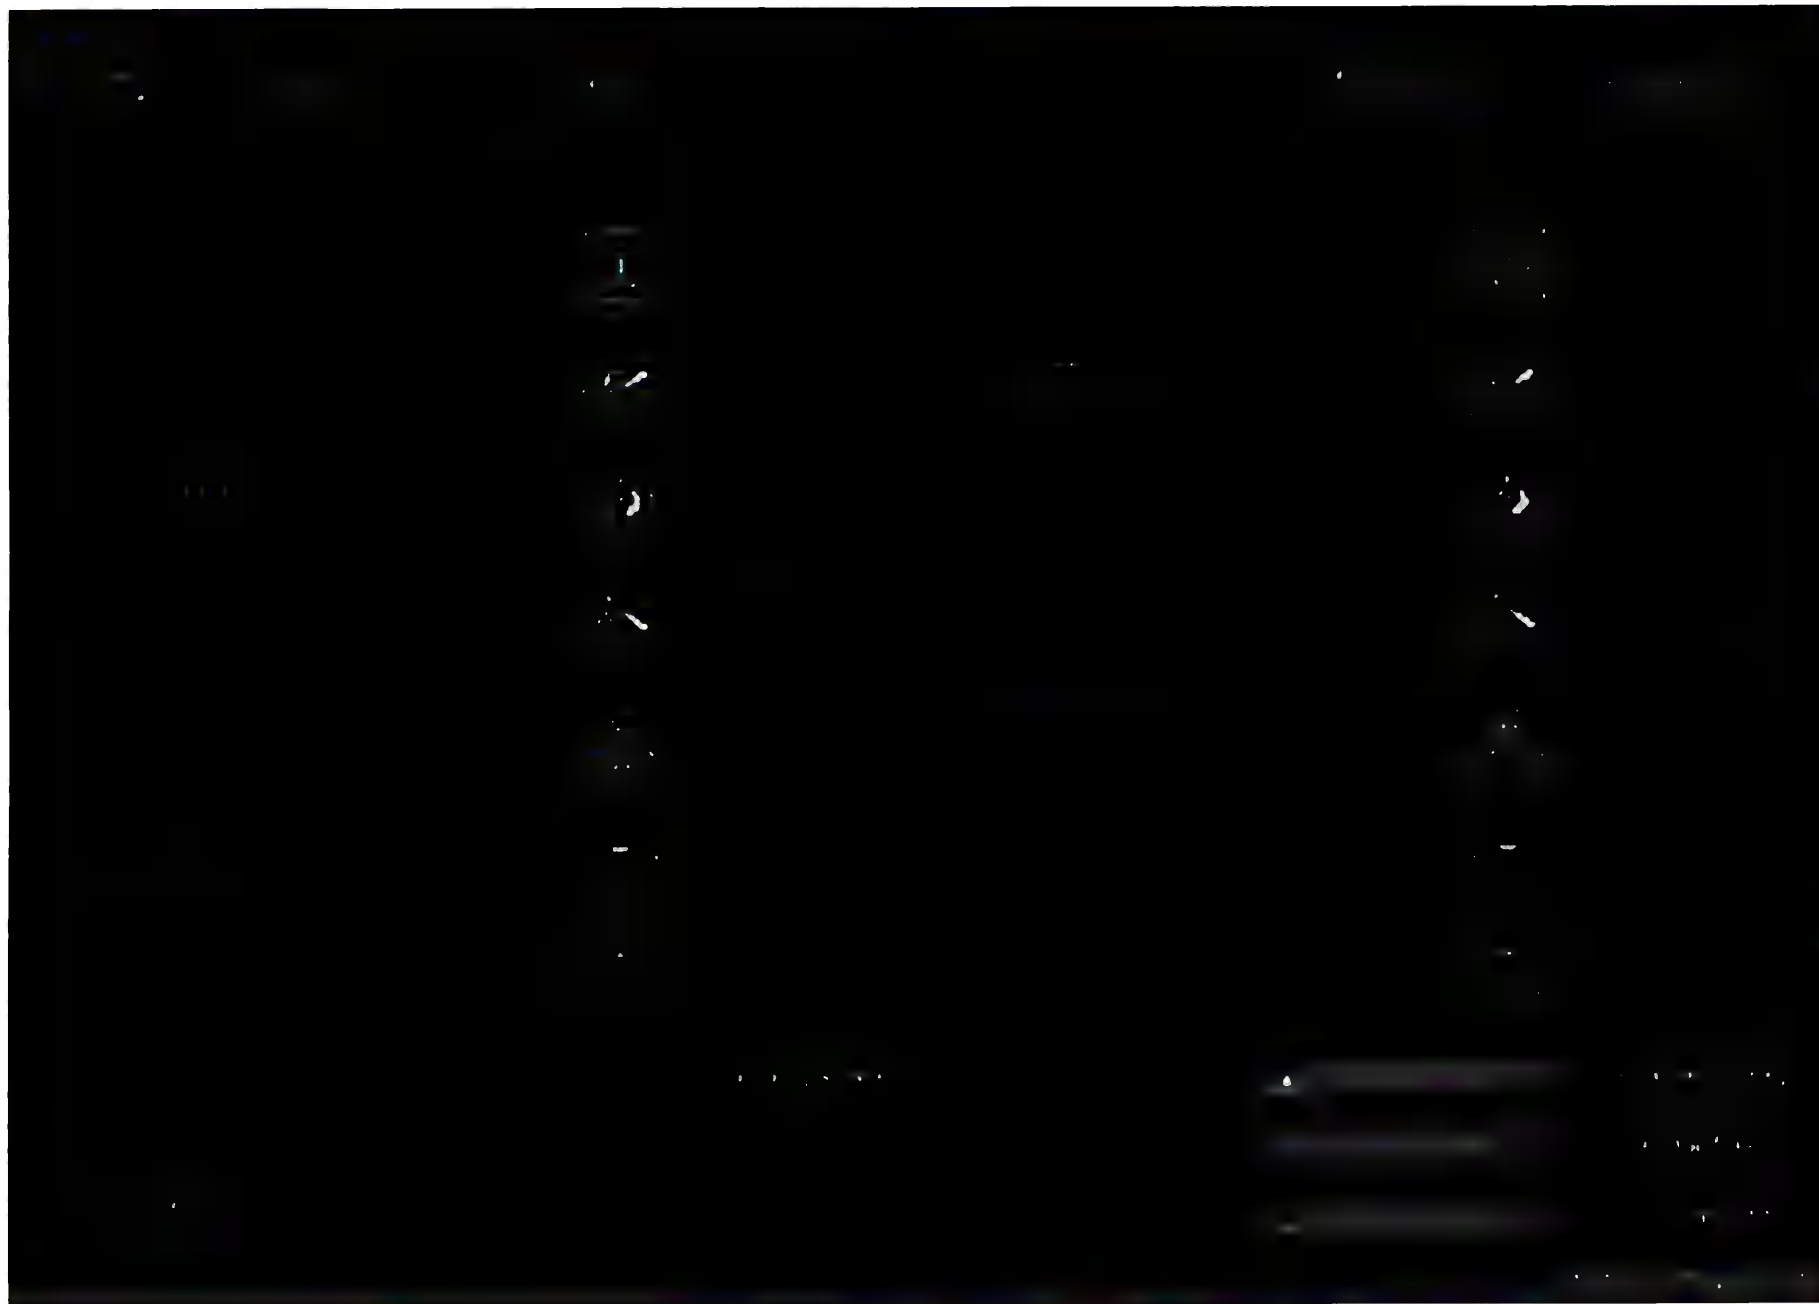

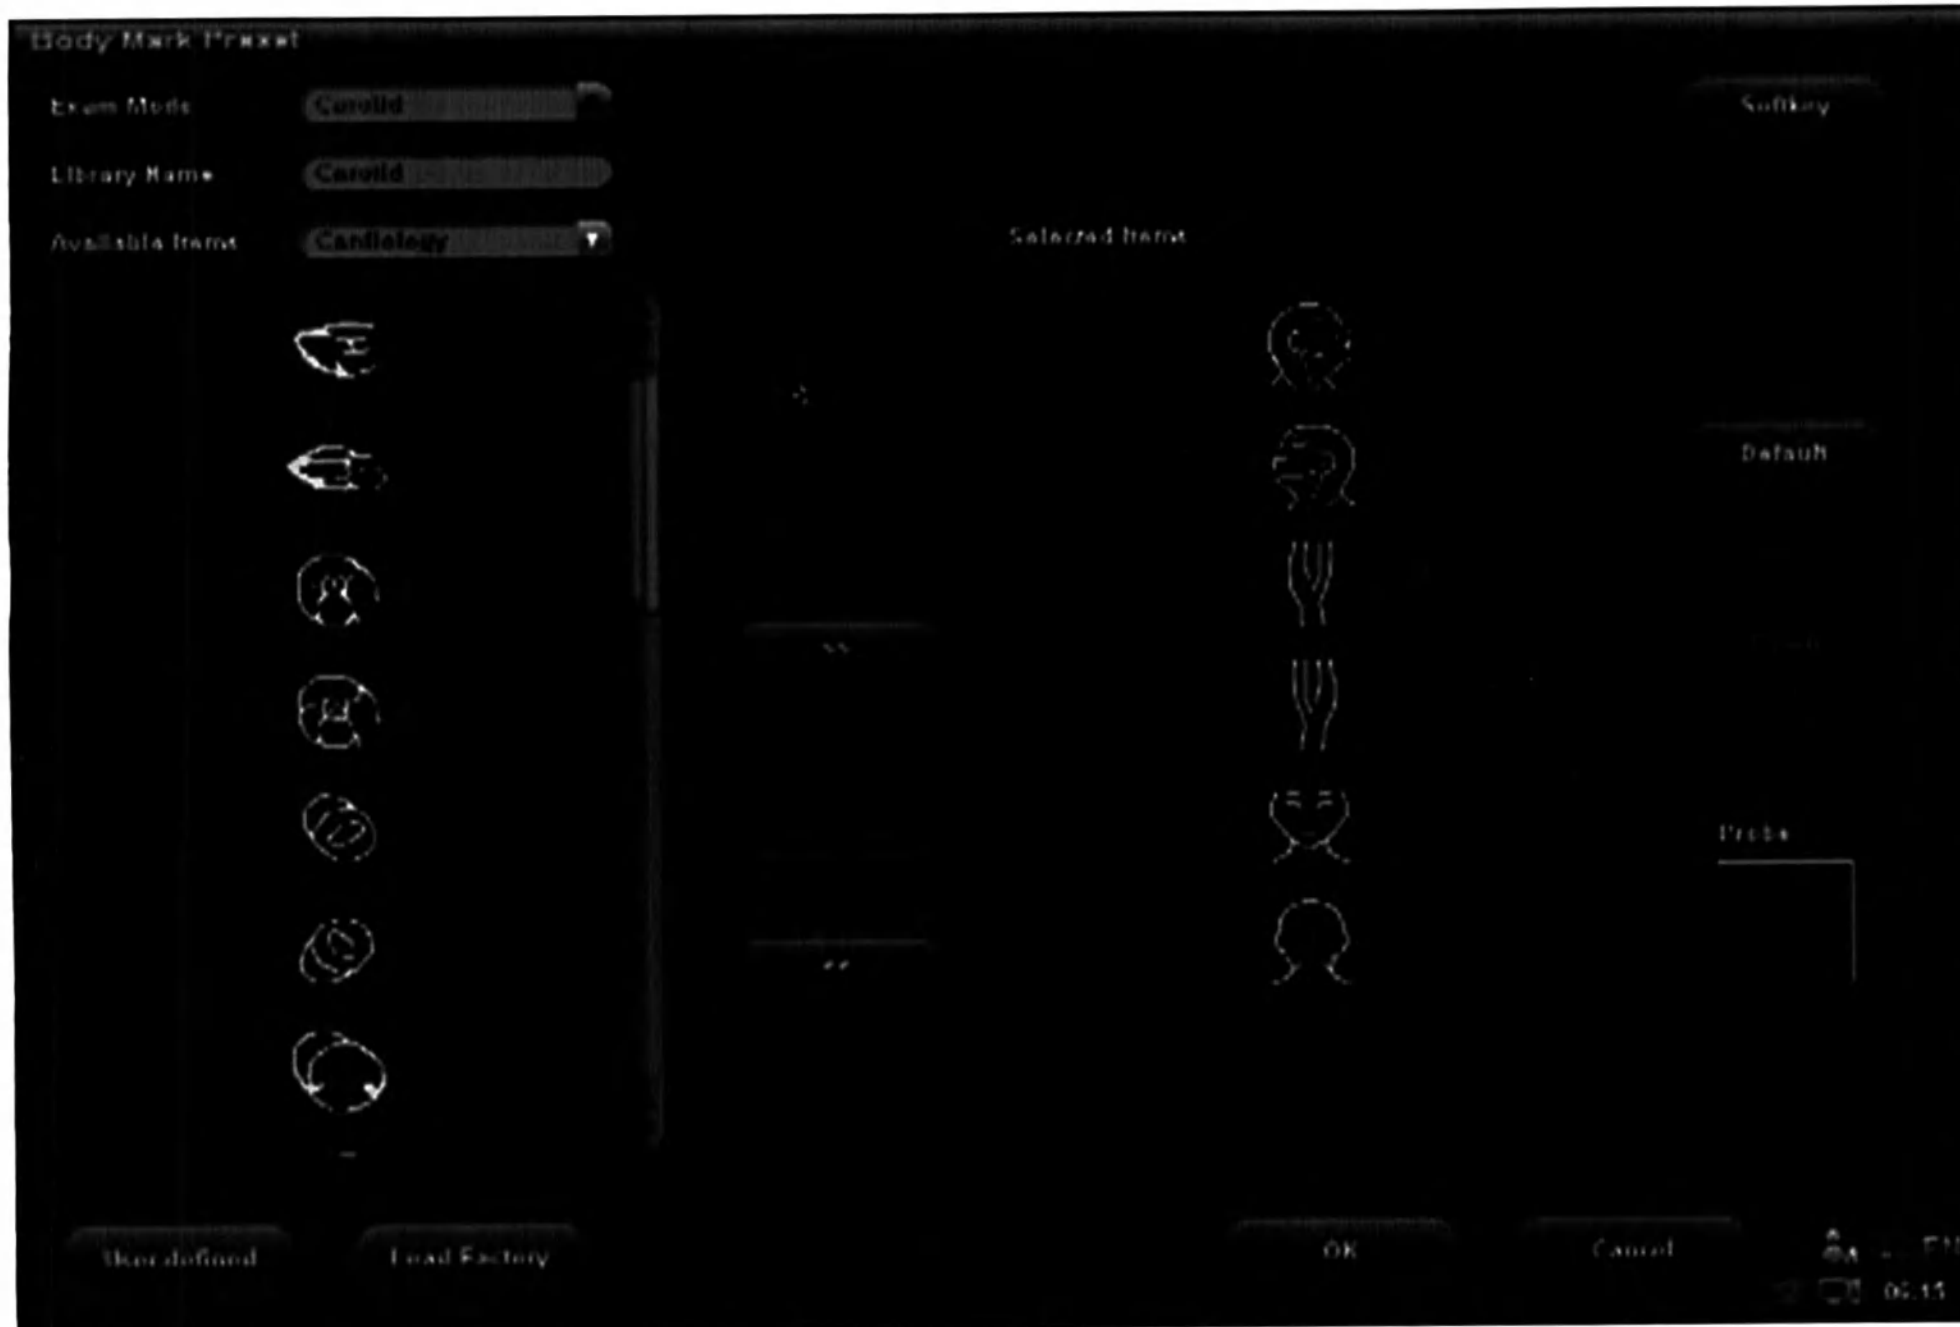

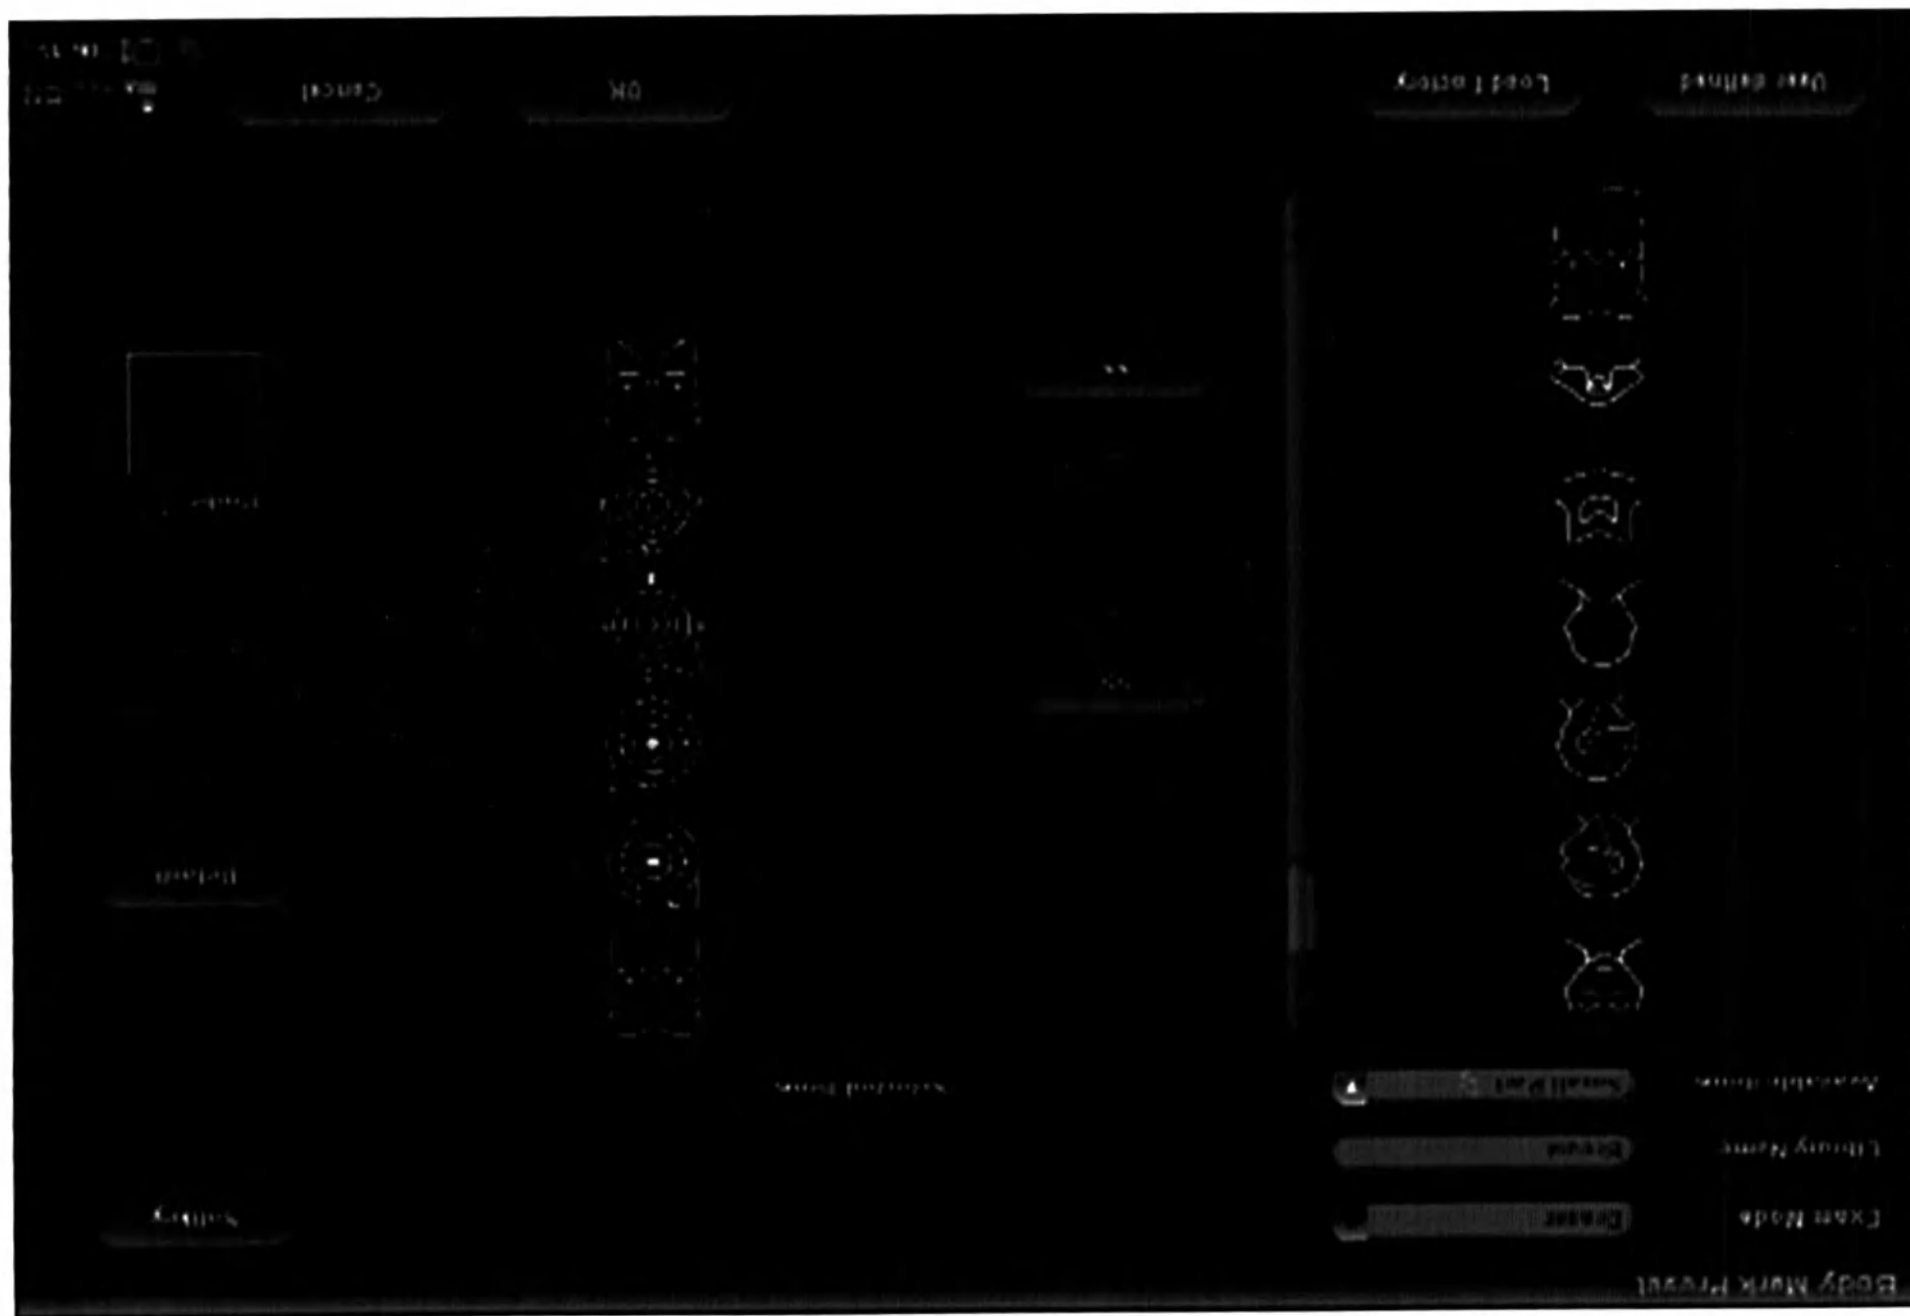




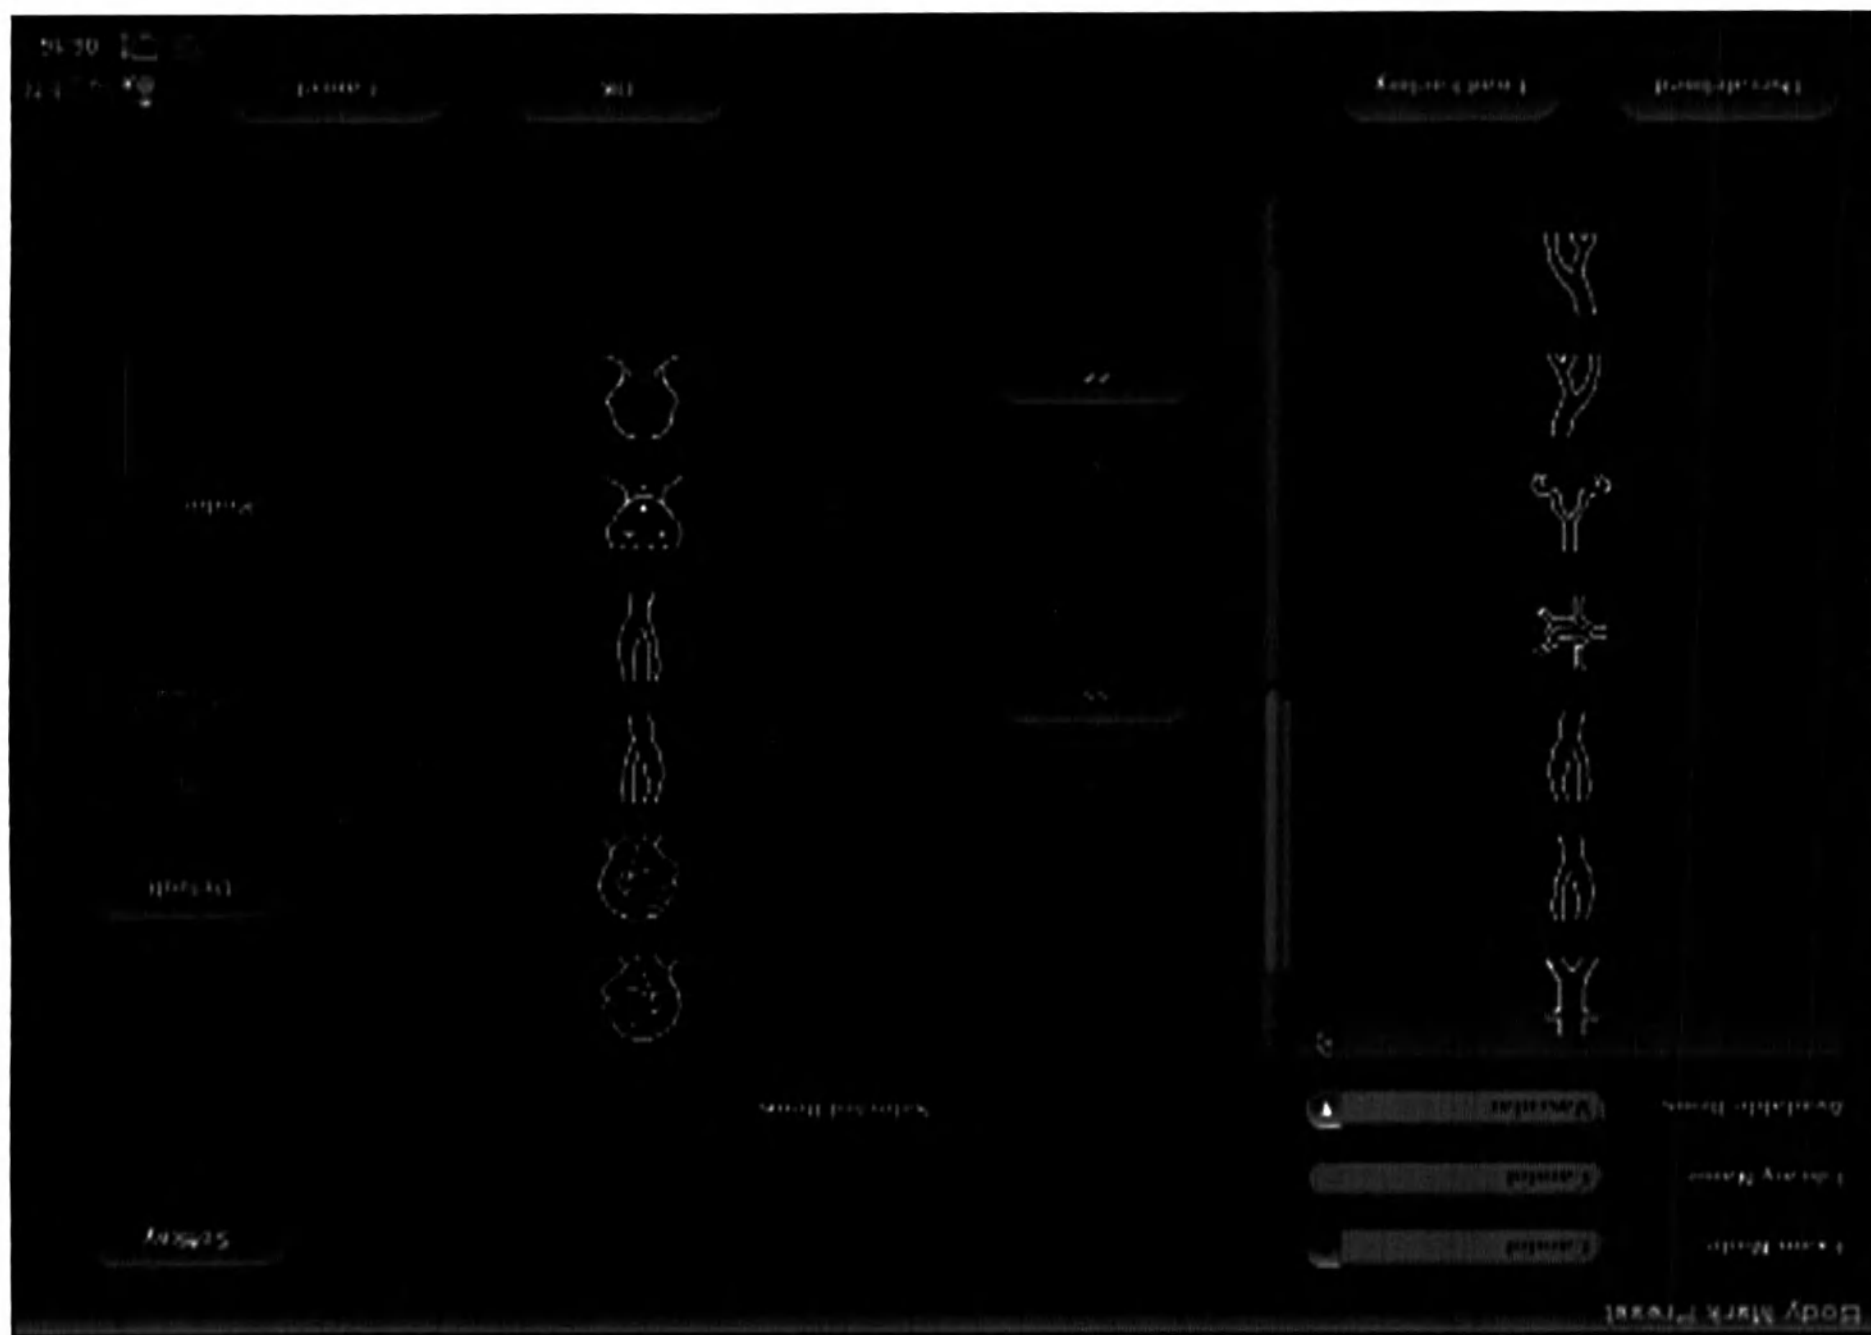





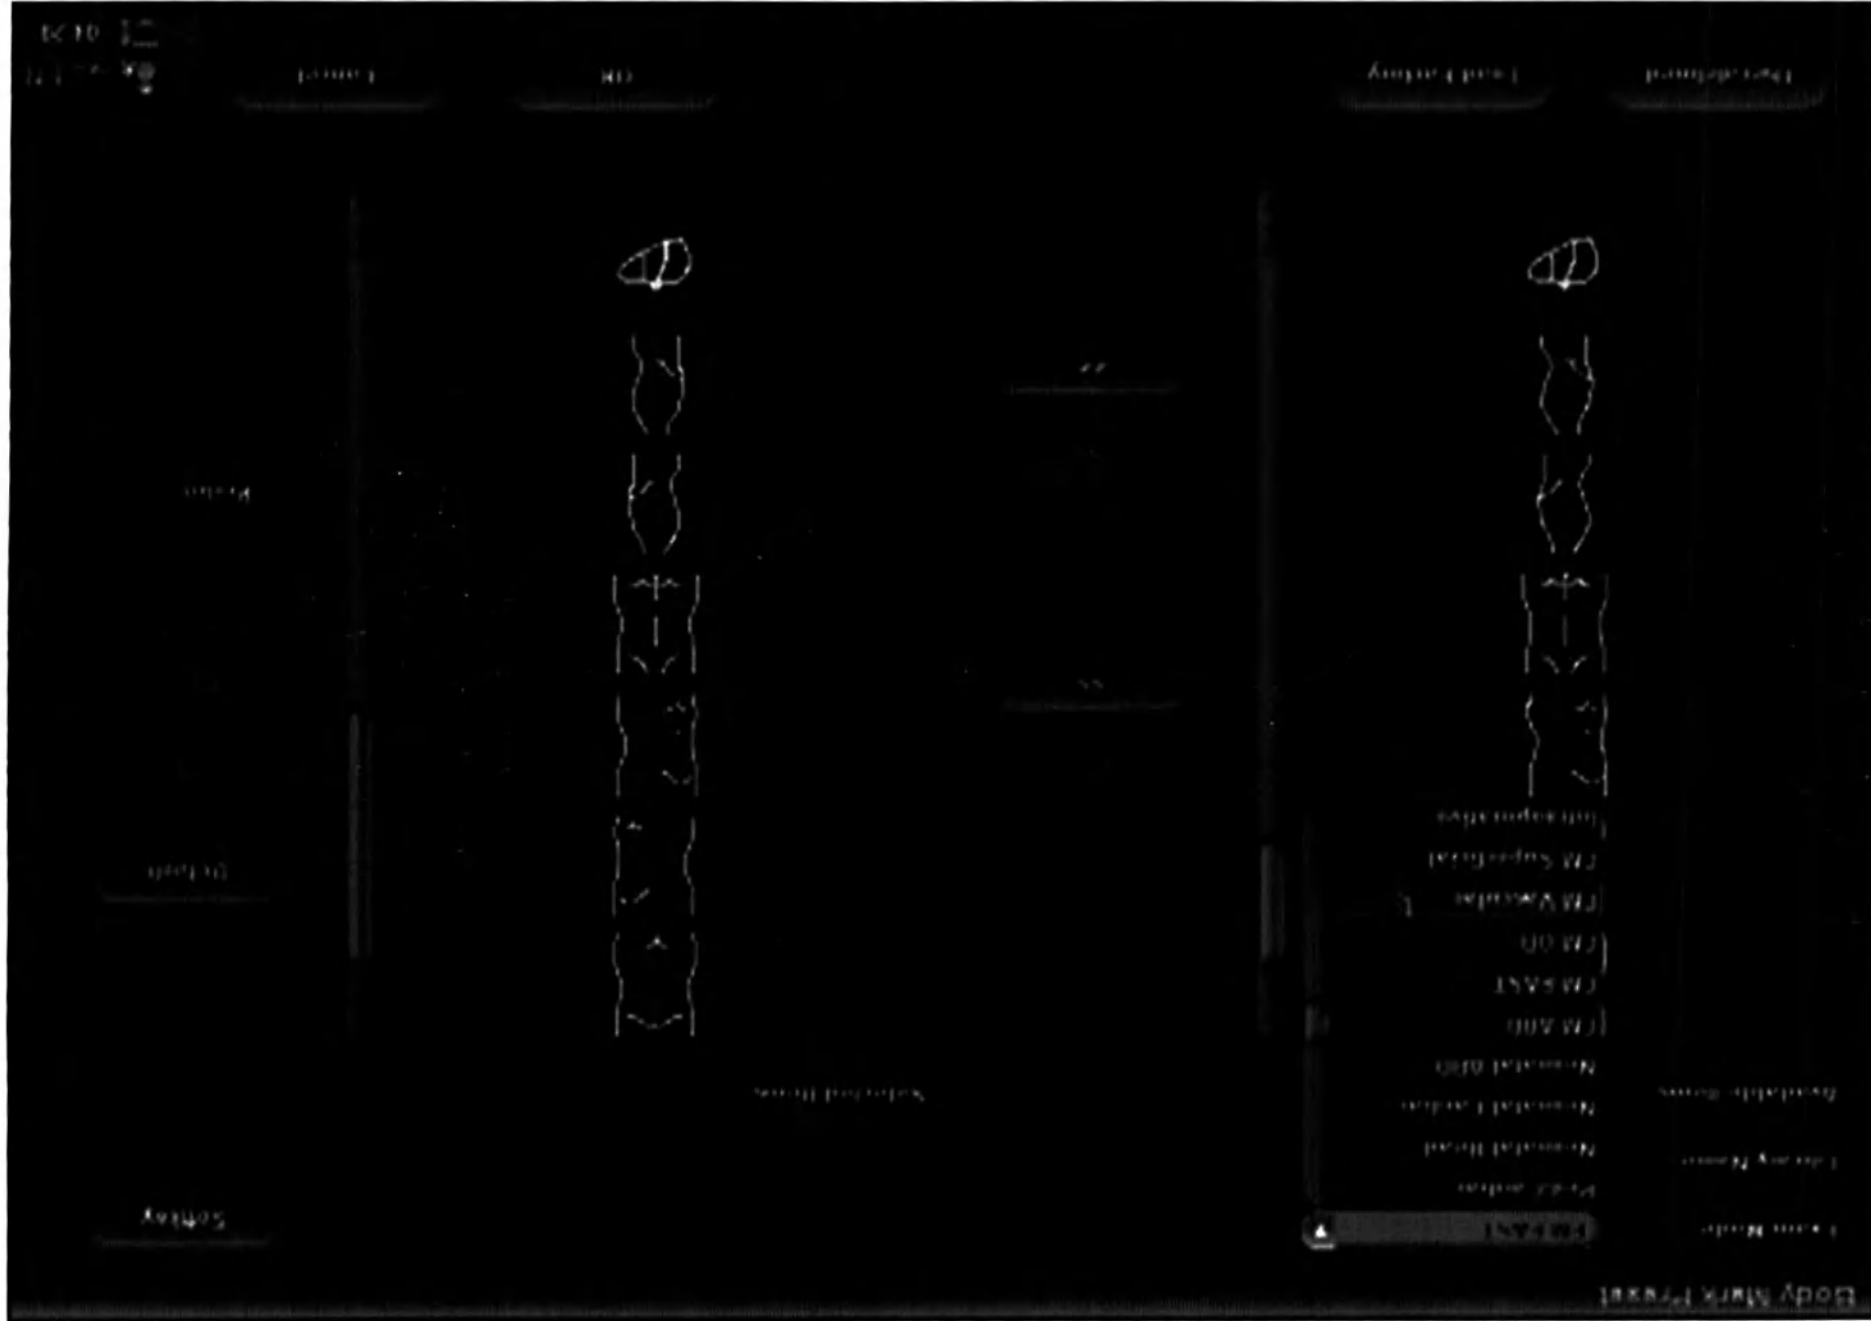

26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 25

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Storage		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Storage Print **Worklist** MPPS Storage Commitment Query Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Worklist AE Title: Port: 104

Maximum Retry: 1 Interval Timeout(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Scheduled Station AE Title:

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1:	12	12-Worklist		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

03:36

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage Print Worklist **MPPS** StorageCommitment QueryRetrieve

Configure the New Service

Device Service Name AE Title Port

Maximum Retries Interval Time(sec) Timeout(Sec)

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

03:37

26.15. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device 12 Service Name 12.QueryRetrie AE Title Port 104

Maximum Retries 1 Interval Time(Sec) 15 Timeout(Sec) 15

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12.QueryRetrieve		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query Retrieve

Configure this New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Frame rate

35

SR Storage Option

Add

Cancel

Not Store SR

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List

	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate

35

SR Storage Option

Not Store SR

Add

Cancel

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List

	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR


 Attach SR When Store Images
 Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
 Only Store SR
 Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List		Device	Port	Default
1	12	12-Storage	104	N


 Verification is required!

 EN 02:33


26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)

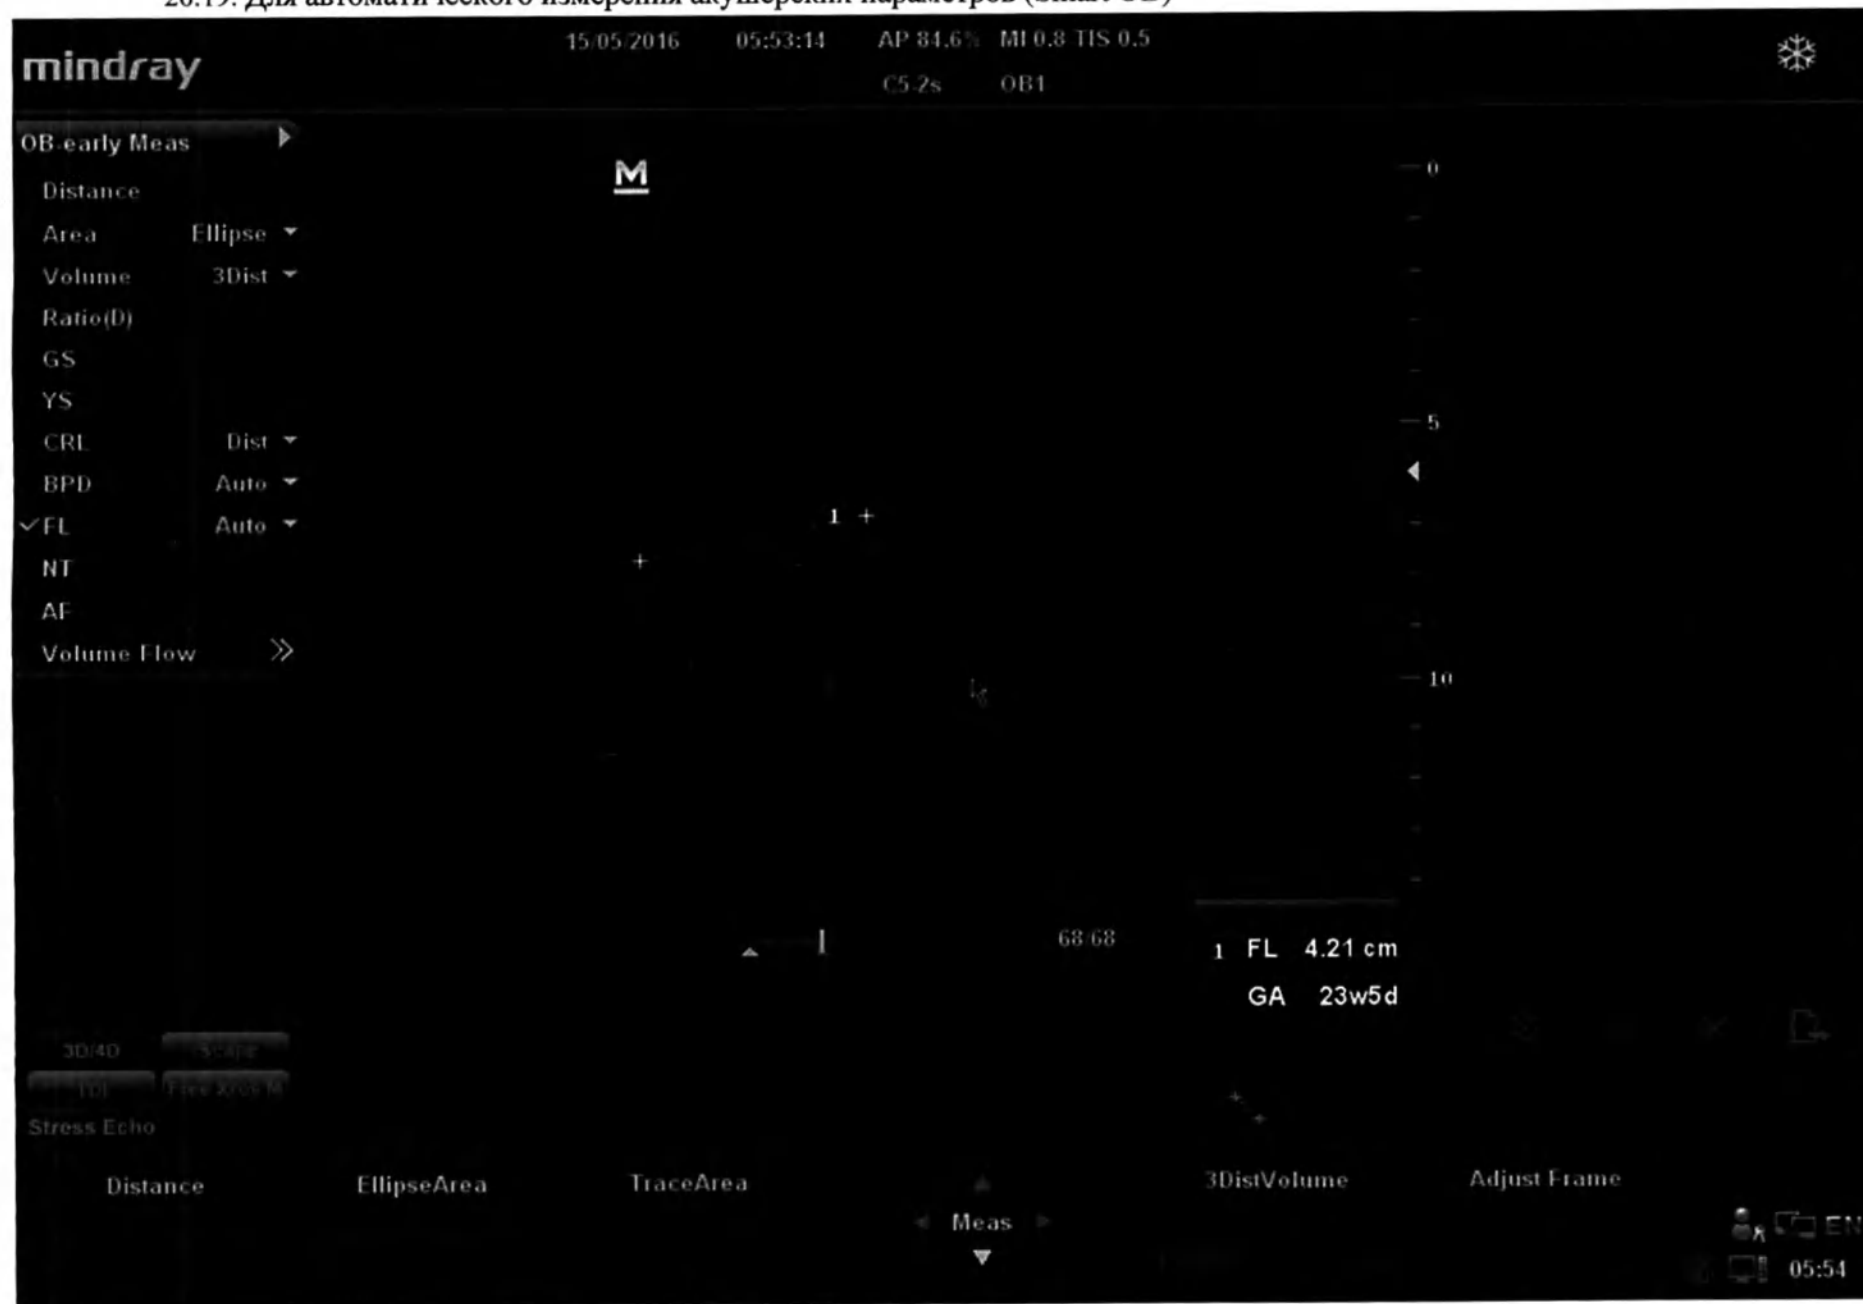


26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)

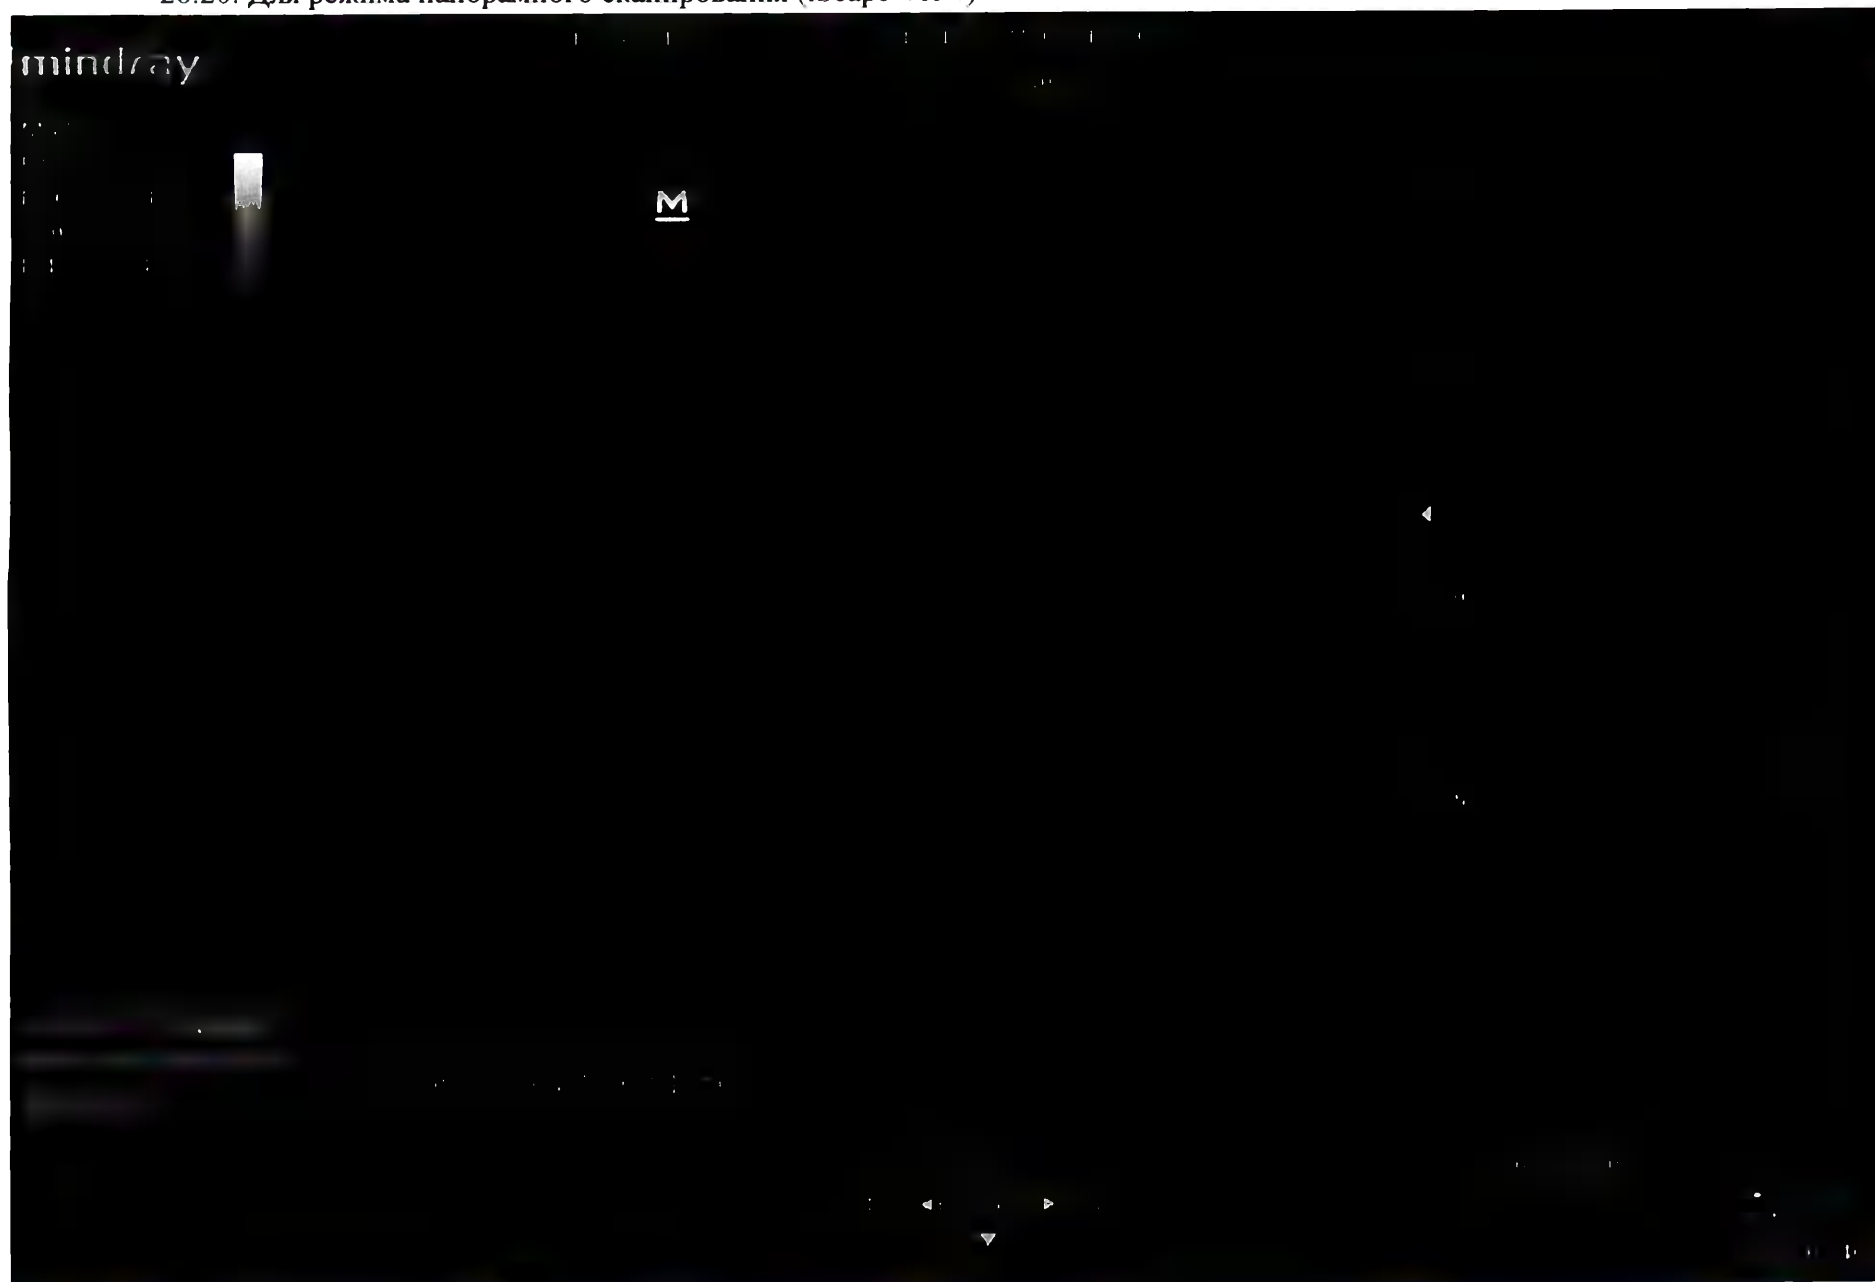


26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)

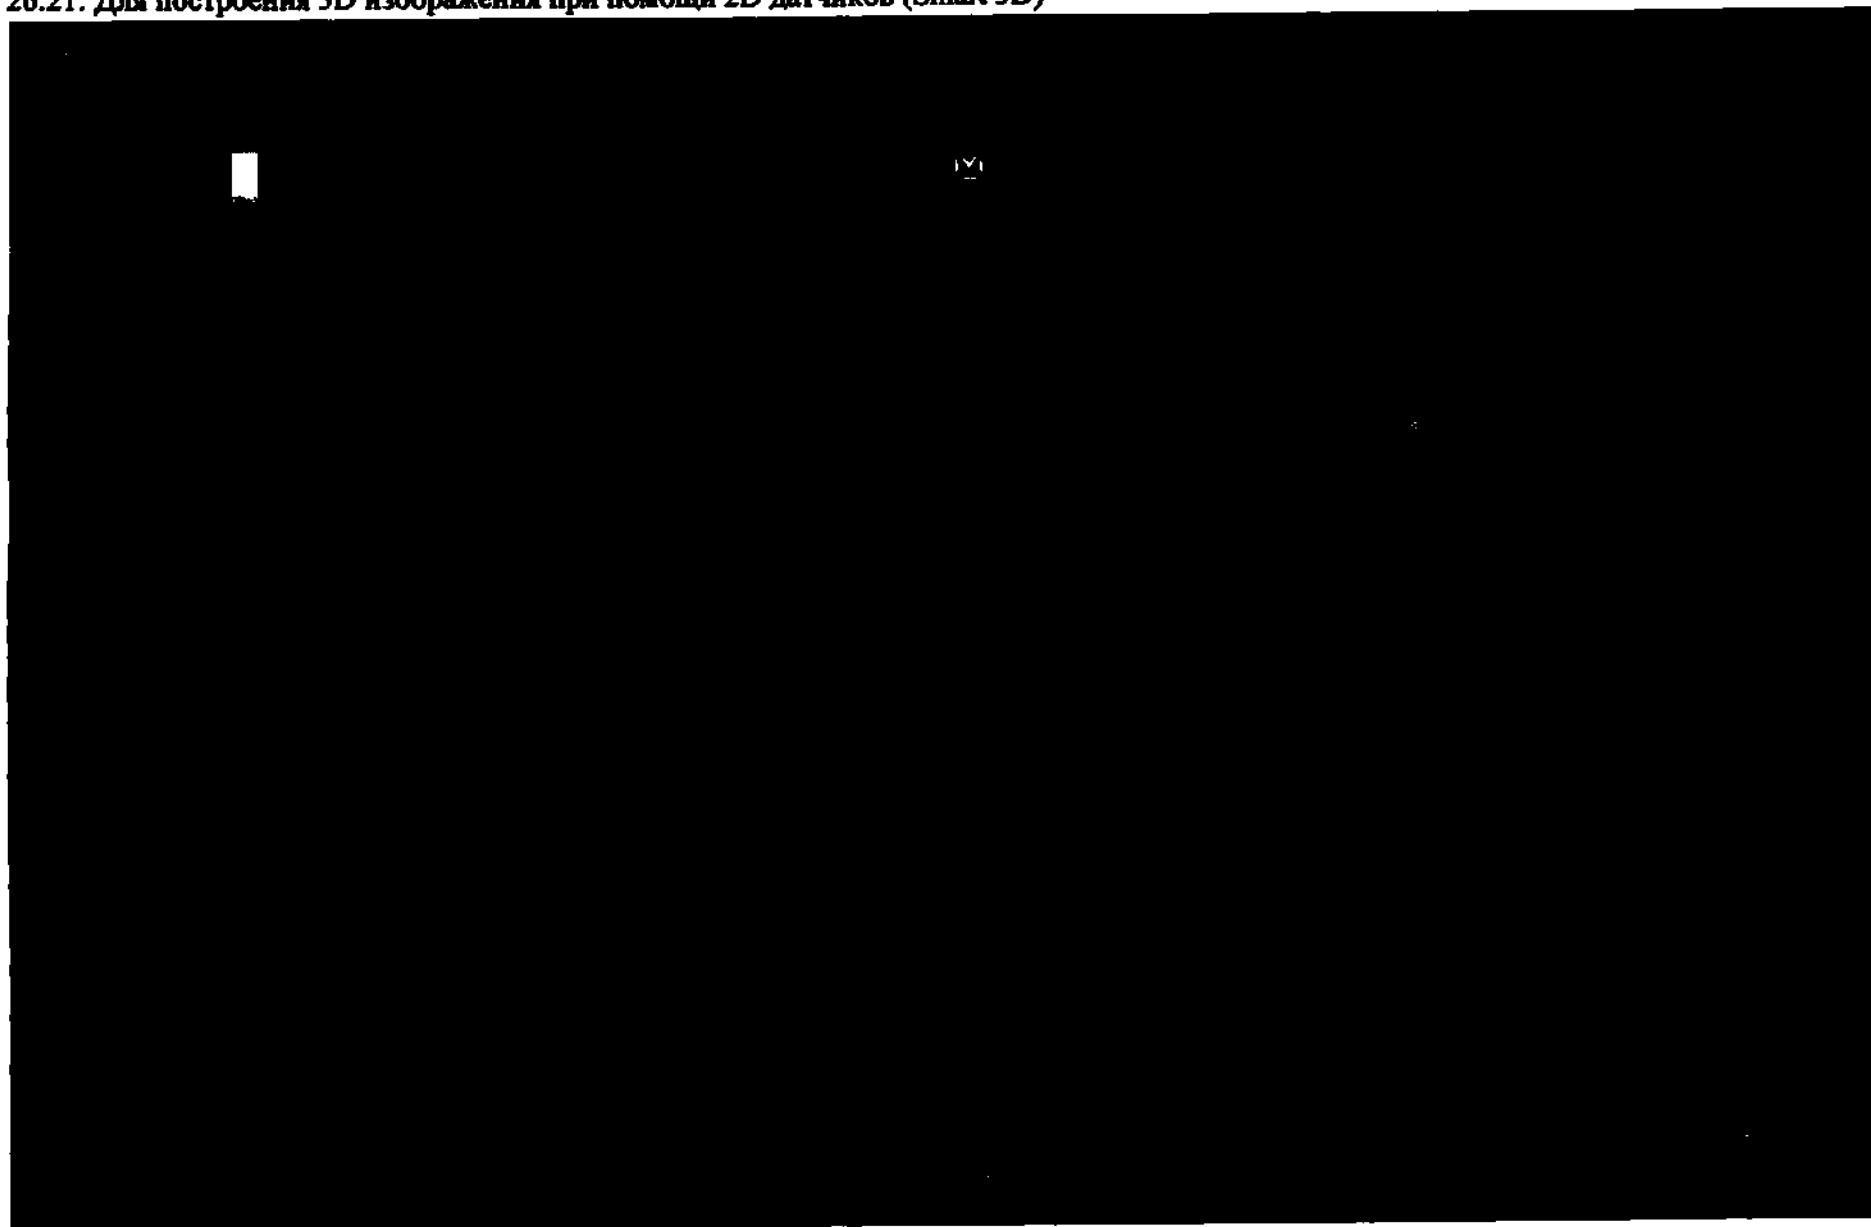

26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)

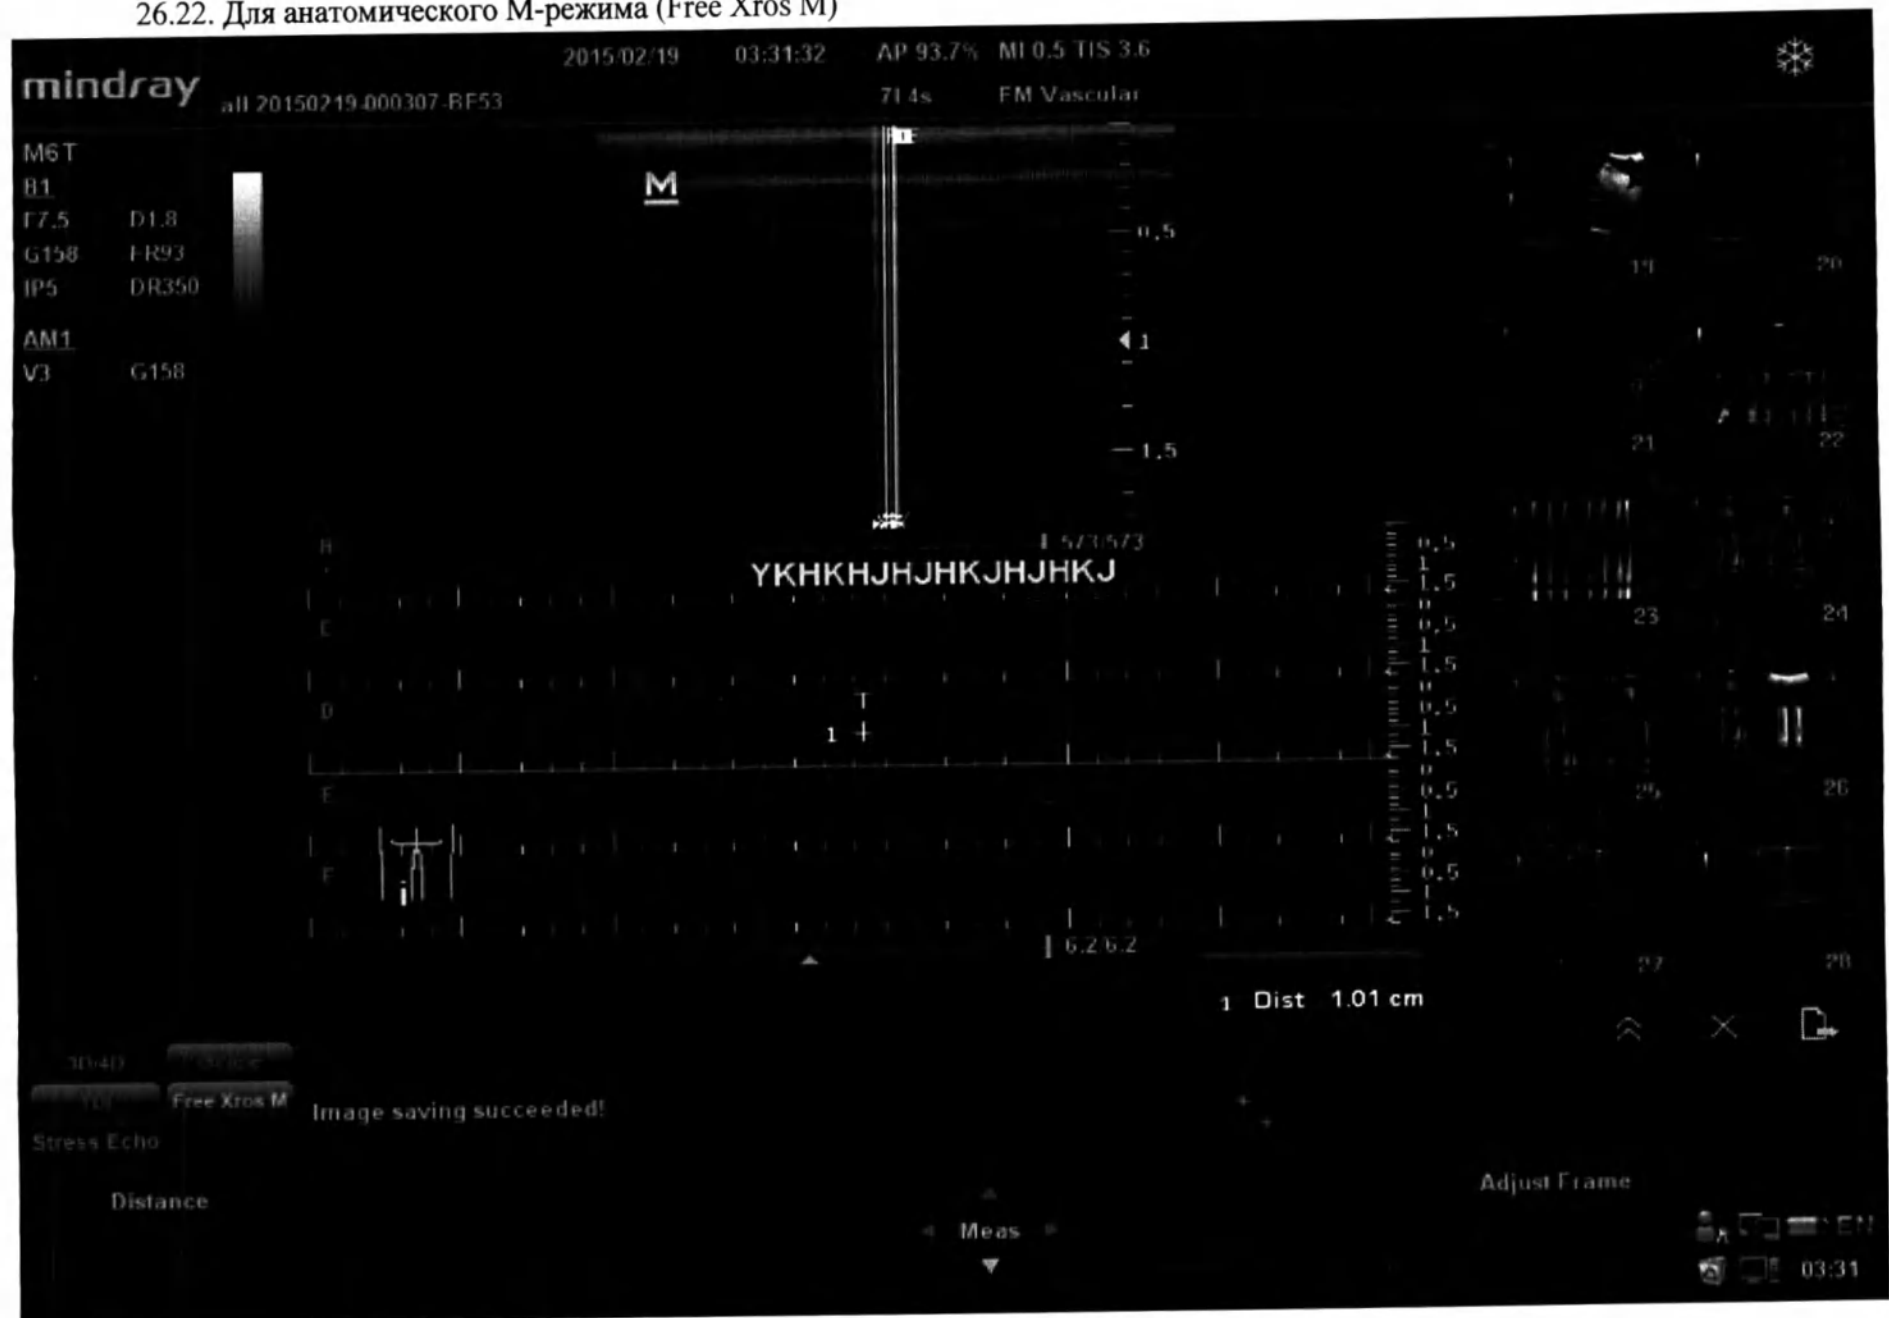

26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)

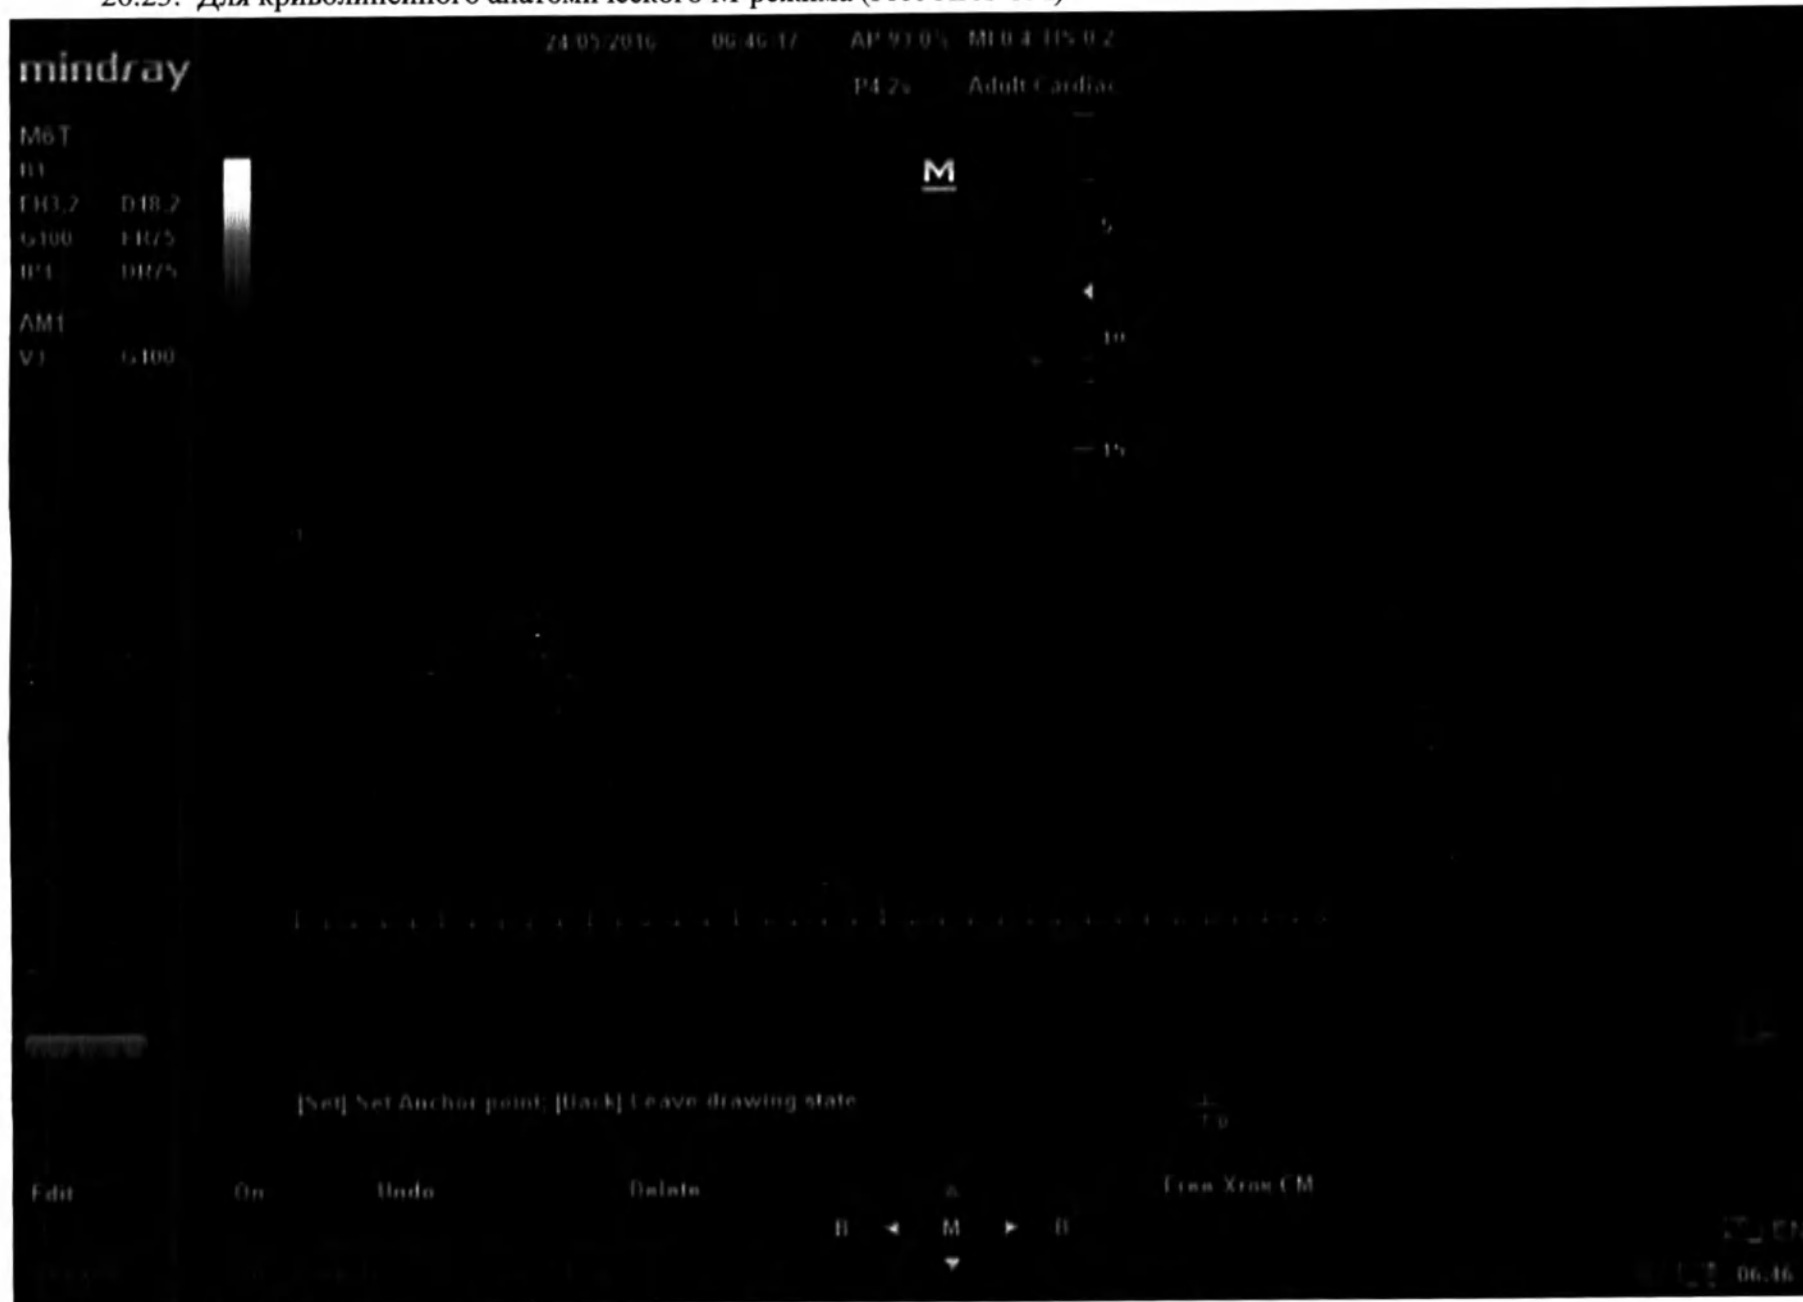

26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)




26.25. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)



26.26. Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo)



26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)

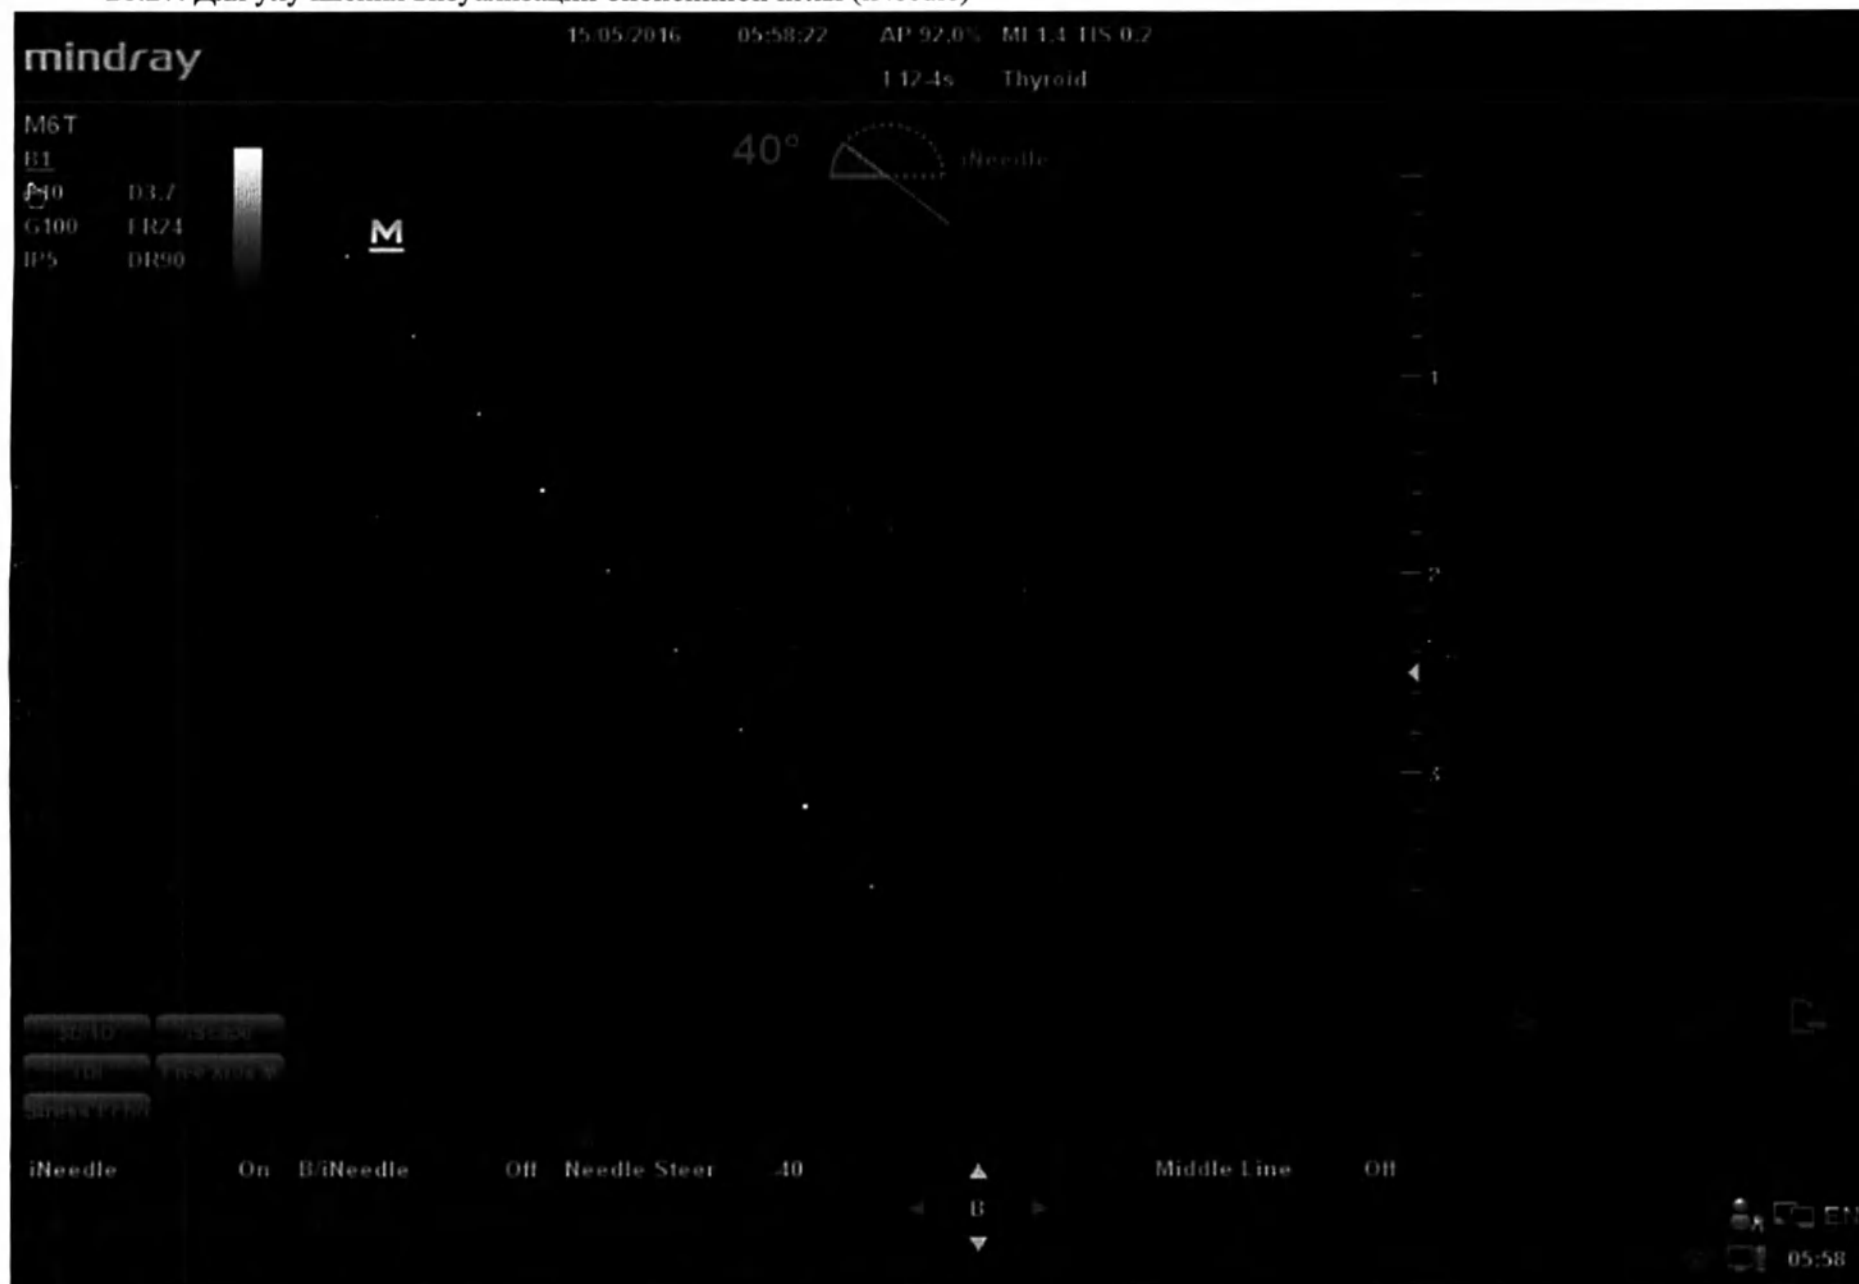

26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)



26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)



26.30. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Body Mark Preset

Exam Mode

Library Name

Available Items

Selected Items

Softkey

Default


Down

Probe

User-defined Load Factory OK Cancel


04:30

26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

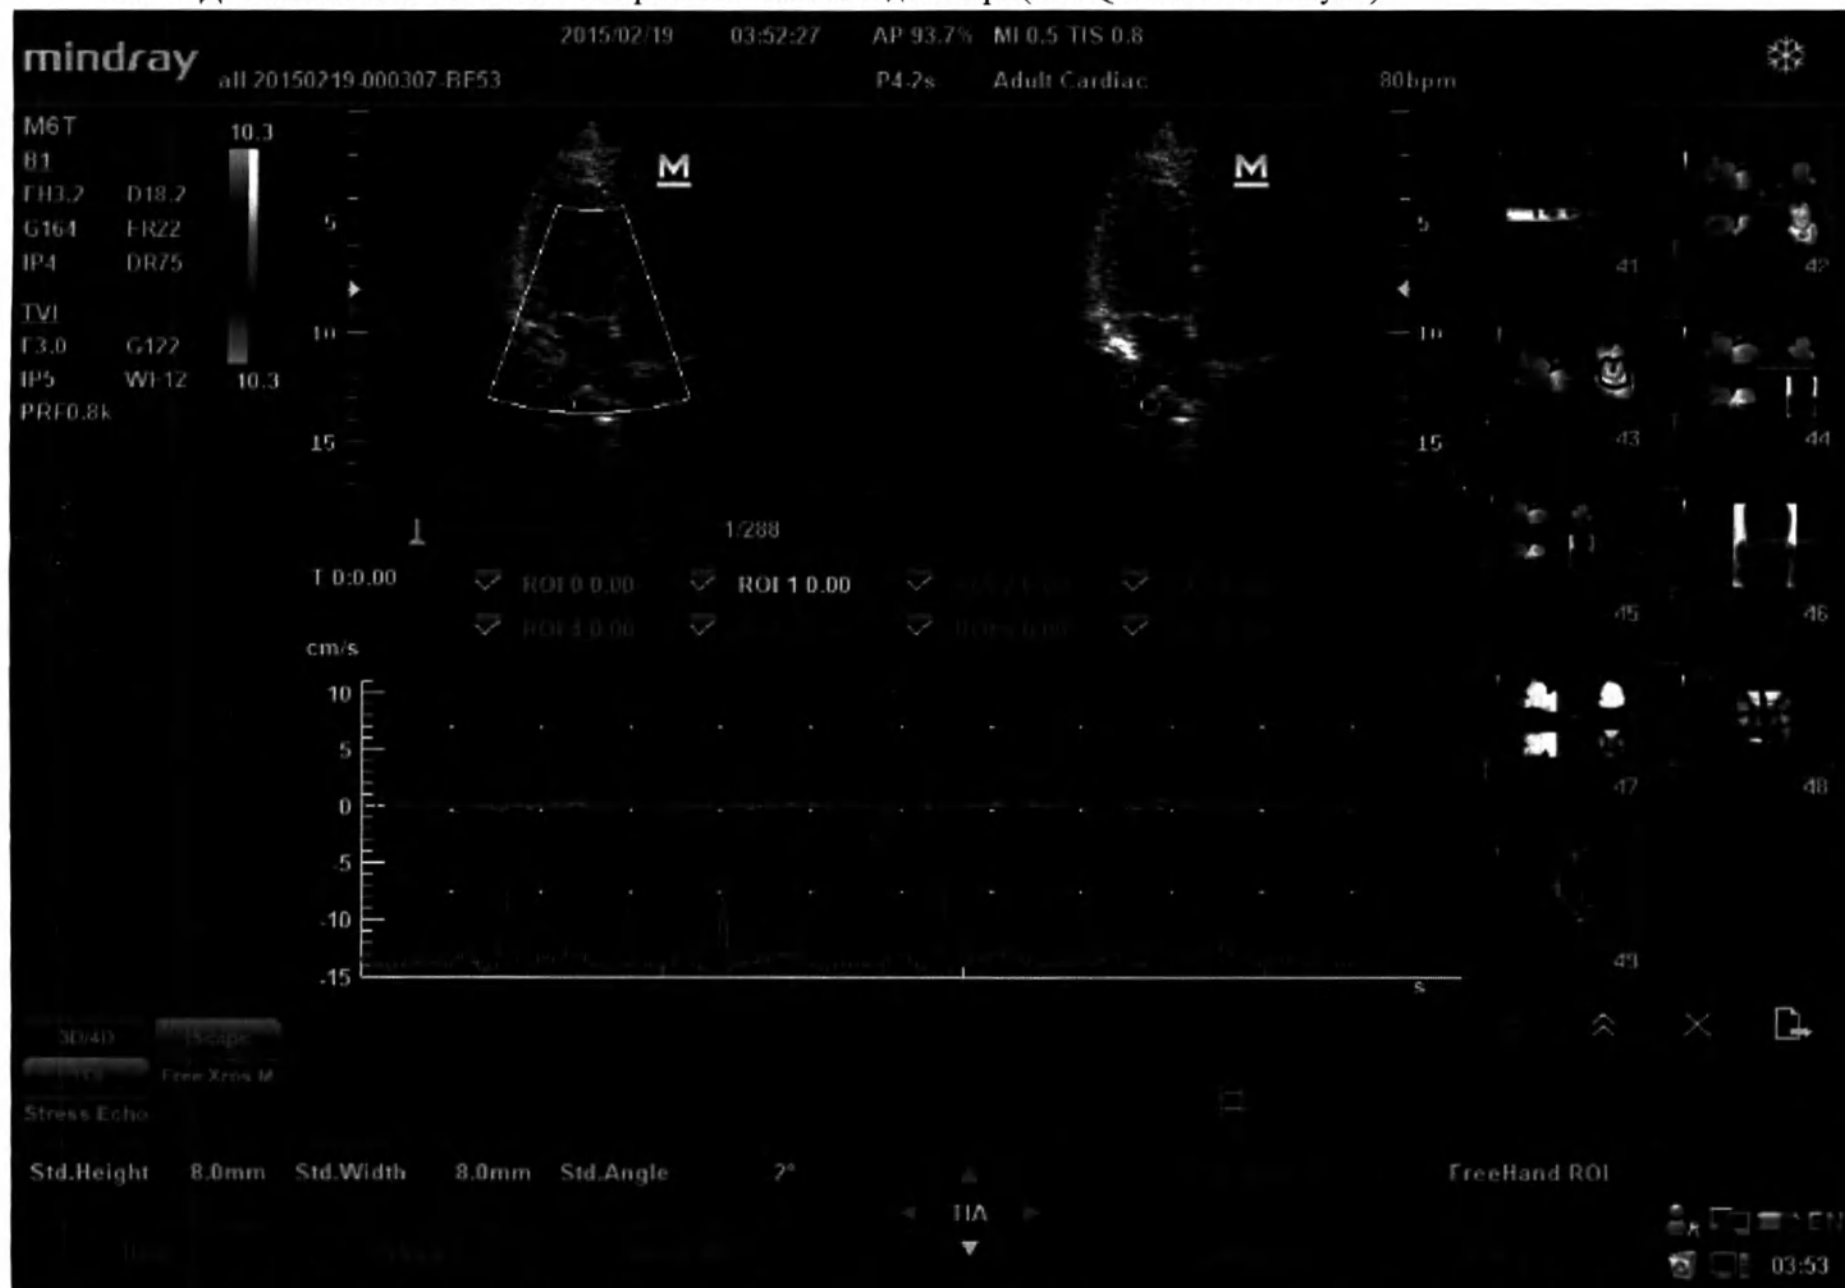



27.Модули:

27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

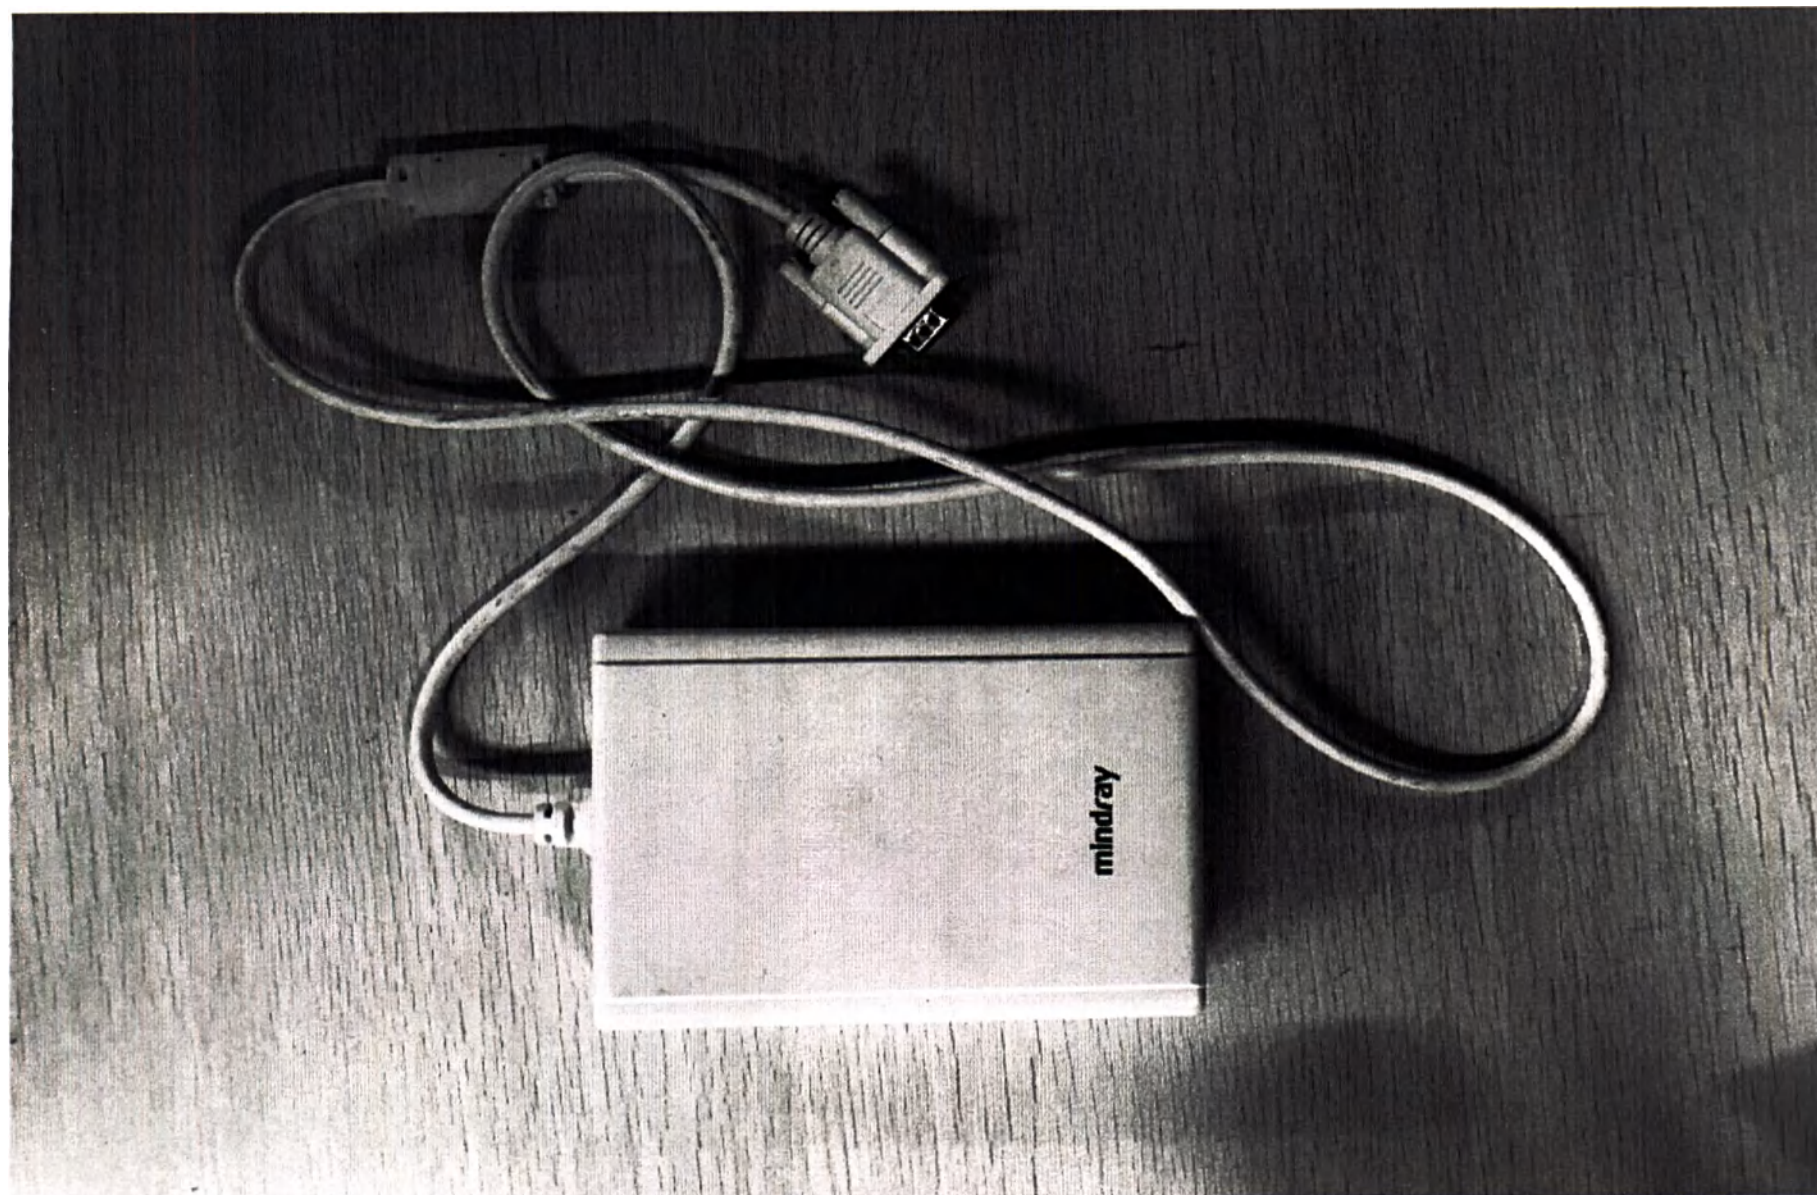




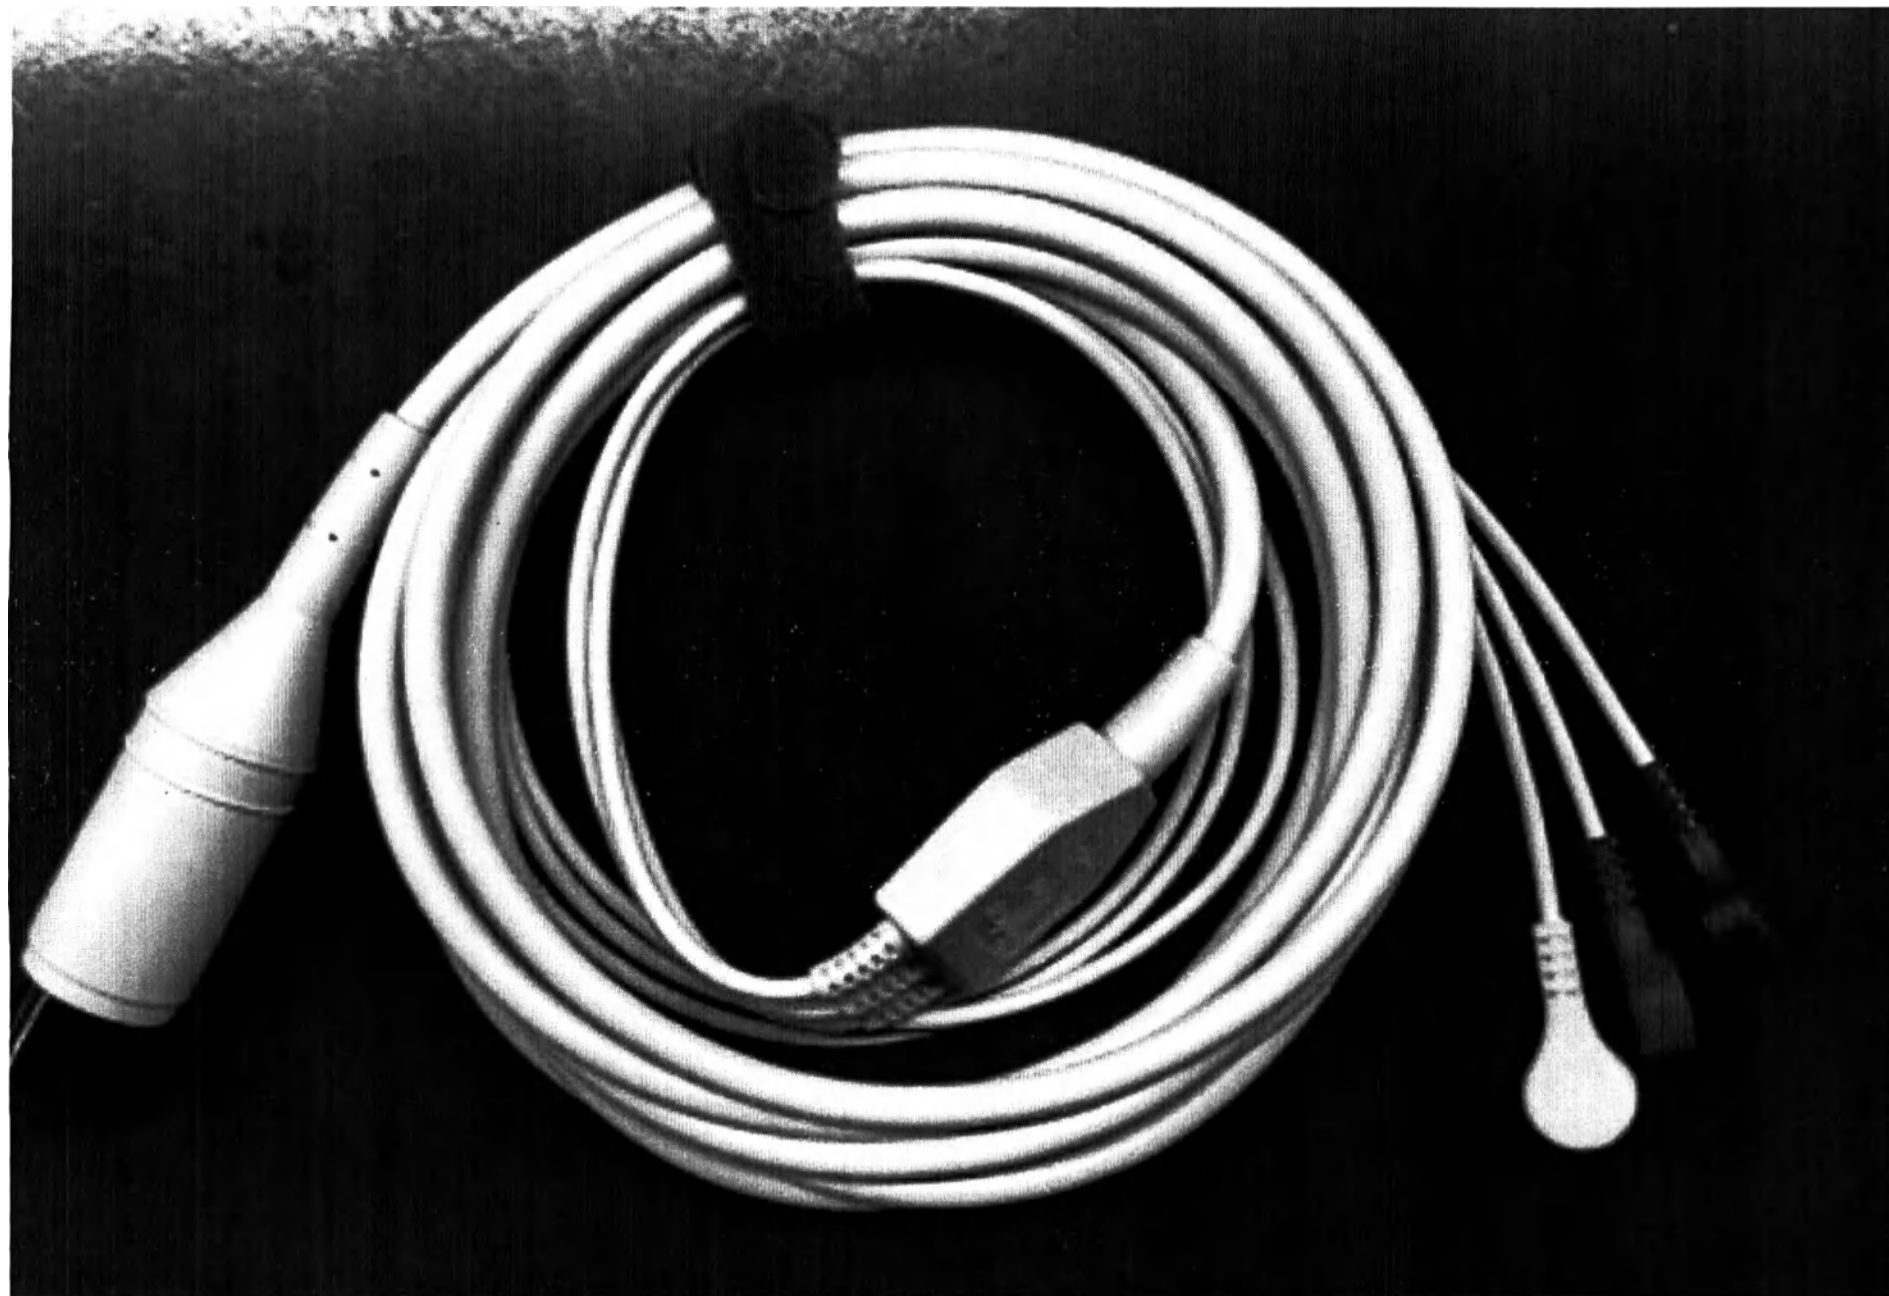

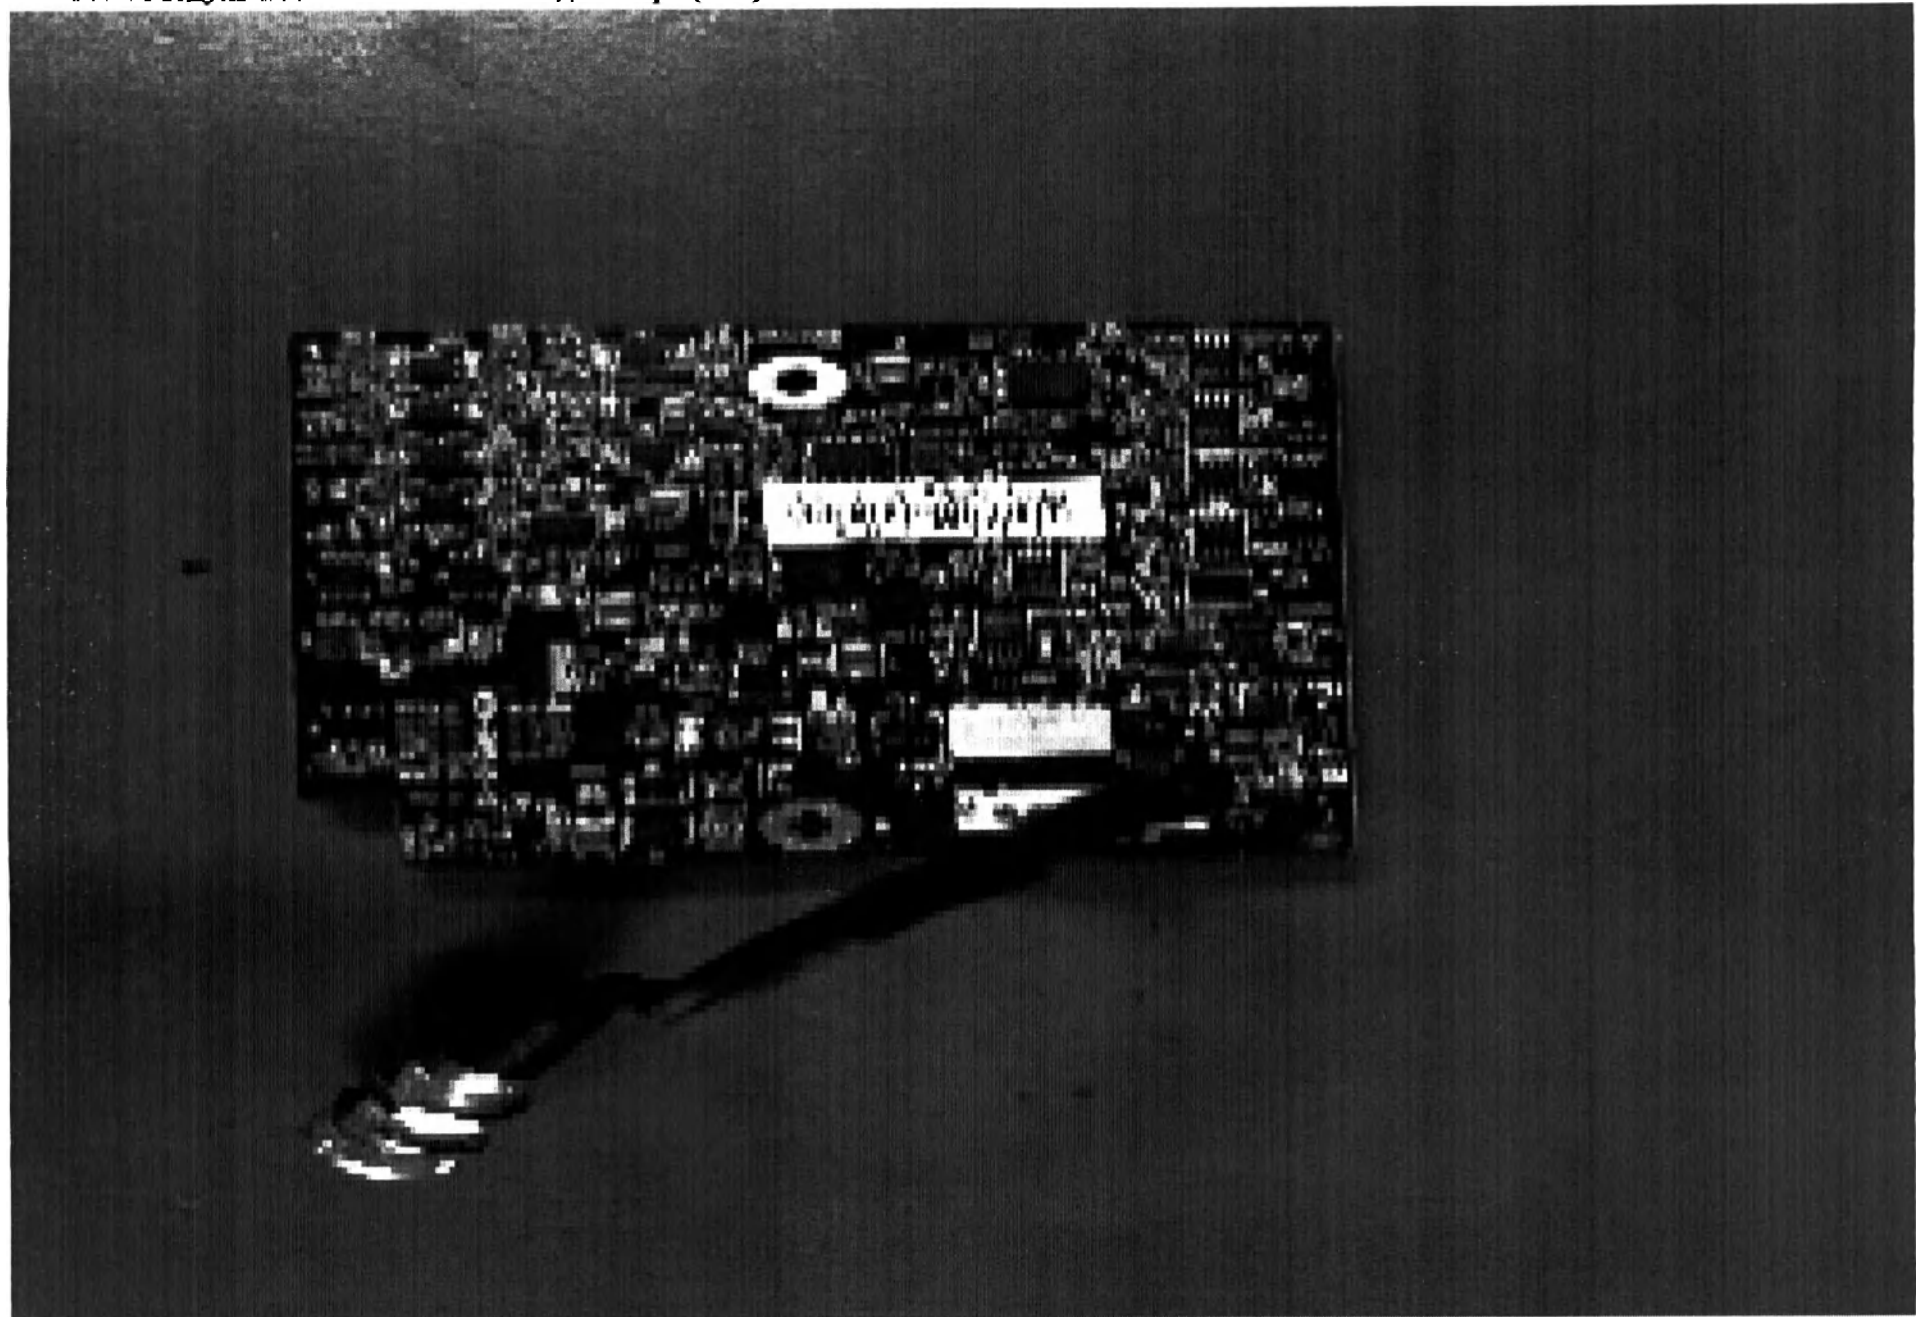



27.5. Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D/TEE Assembly)

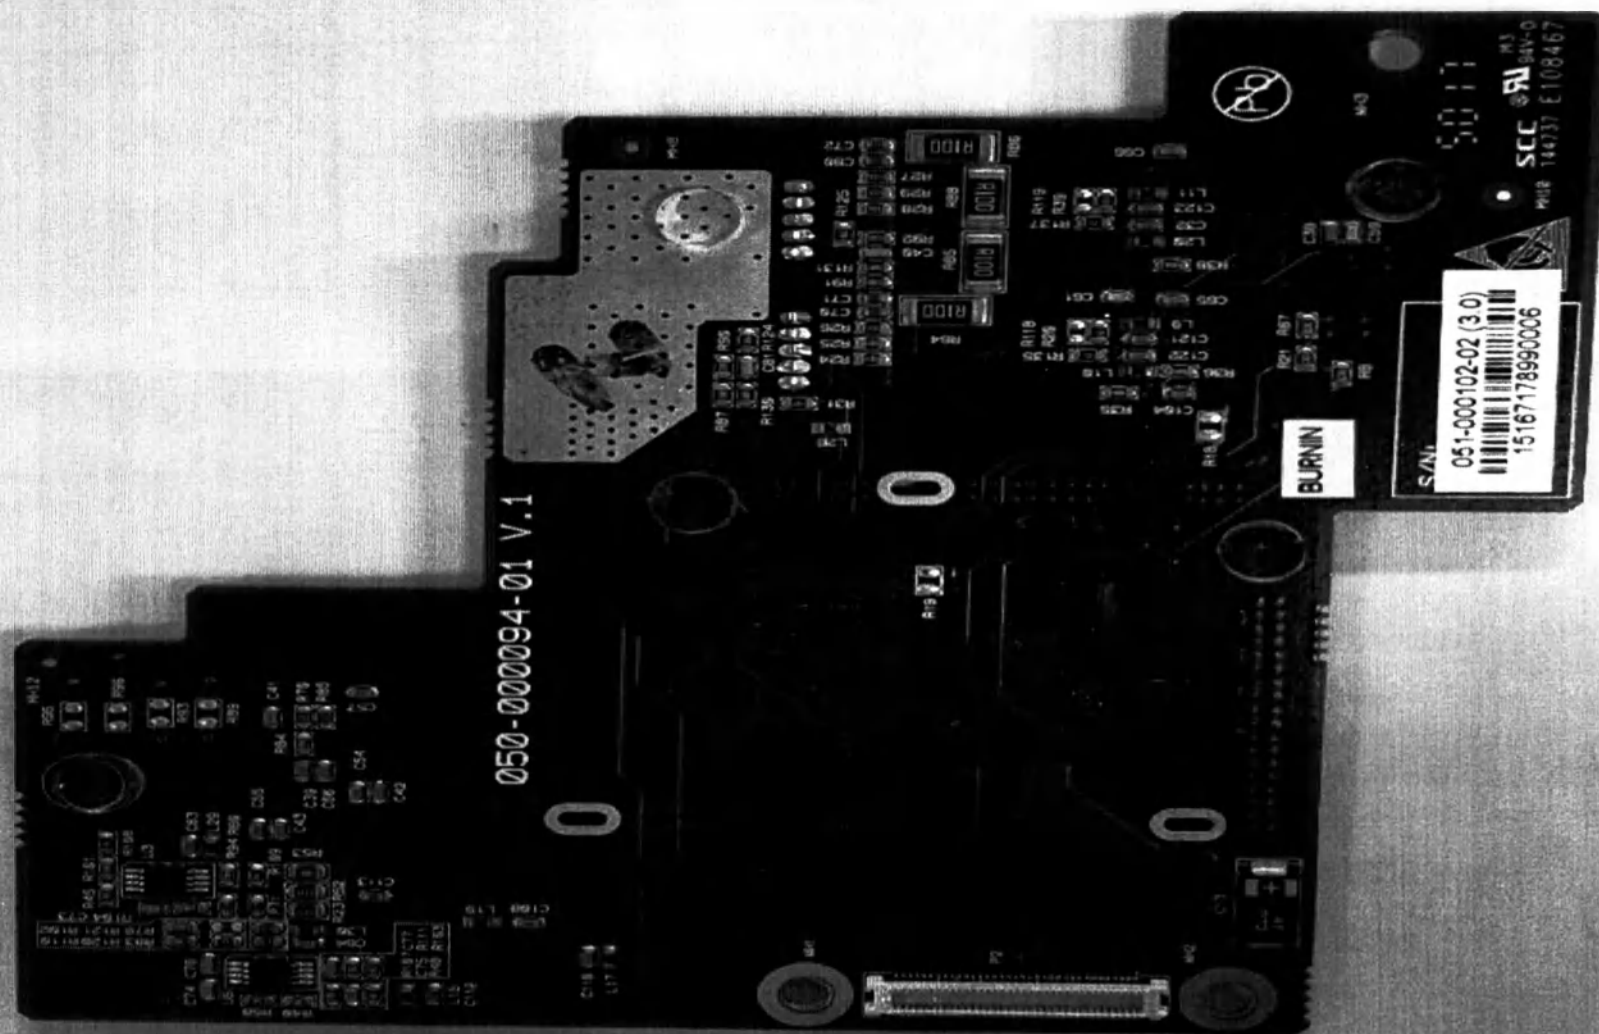



28. Тележки

28. 1 . Тележка мобильная UMT-300

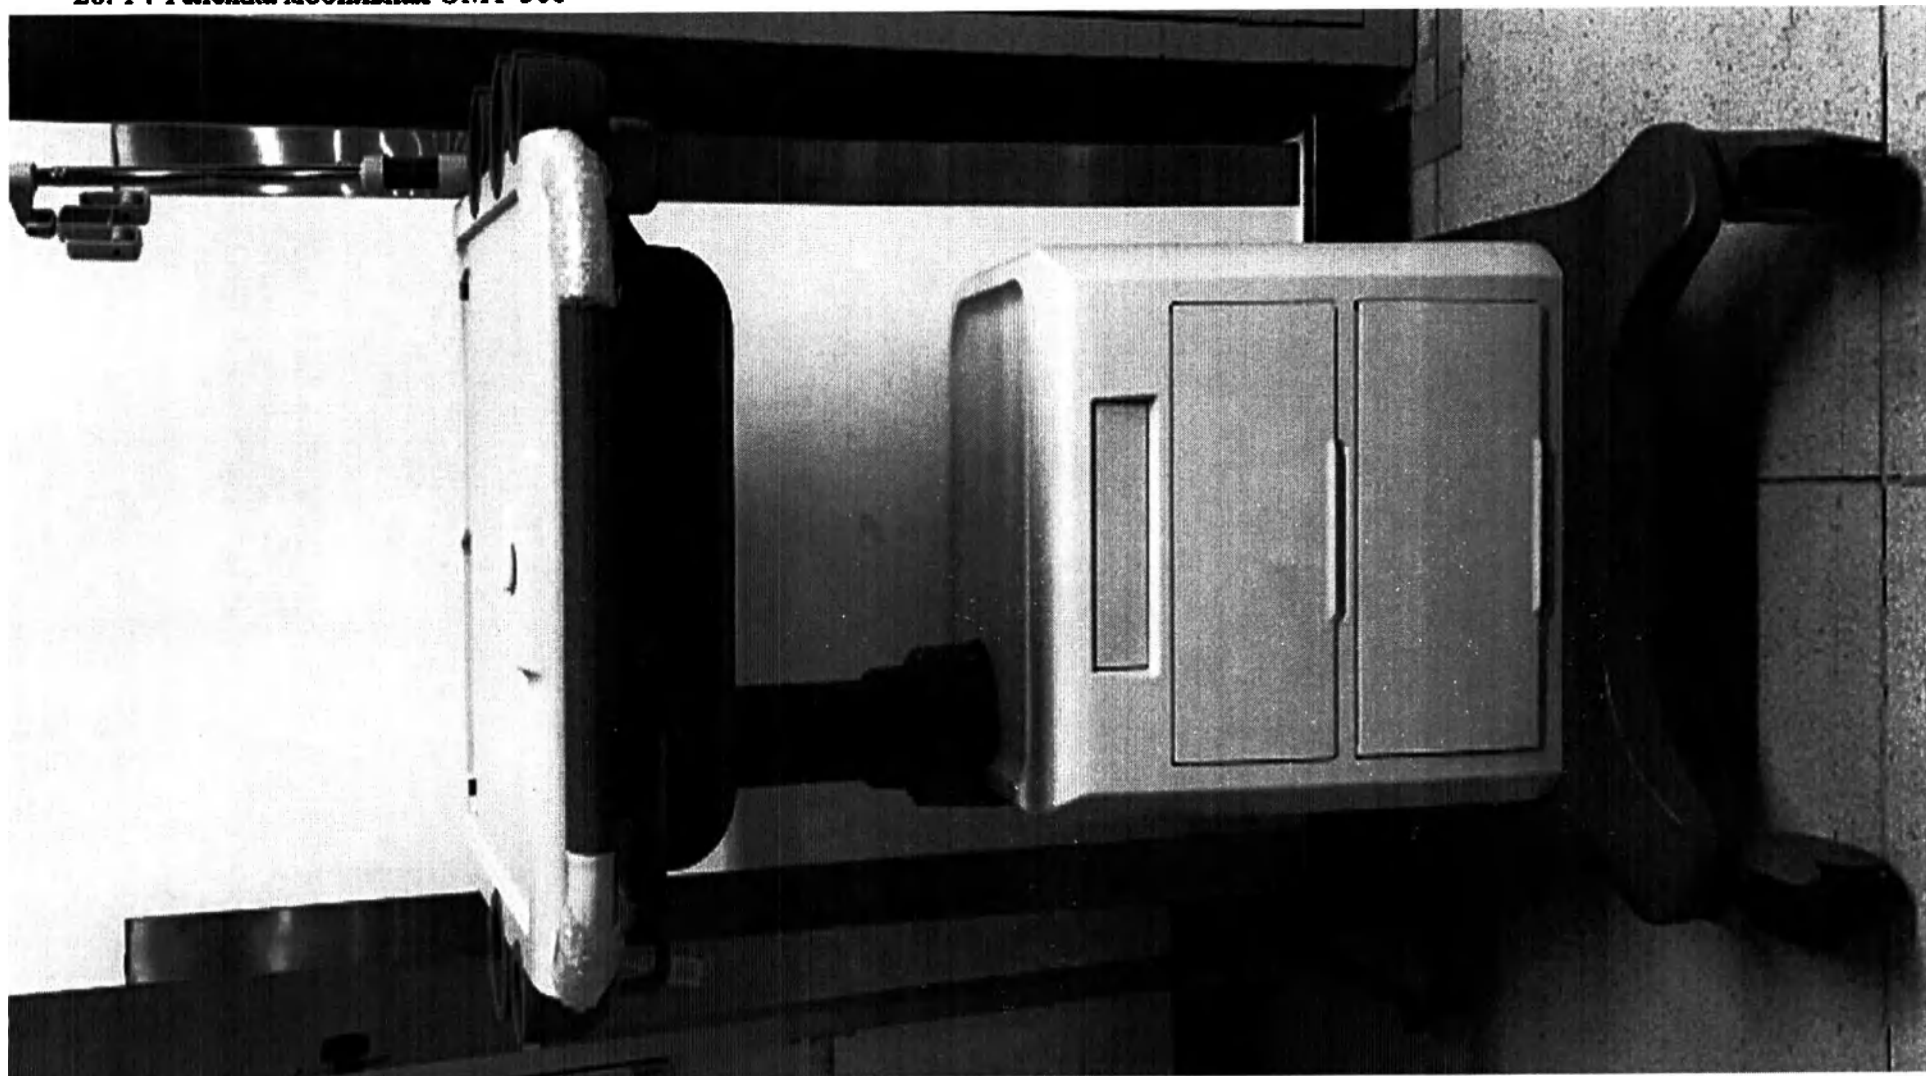

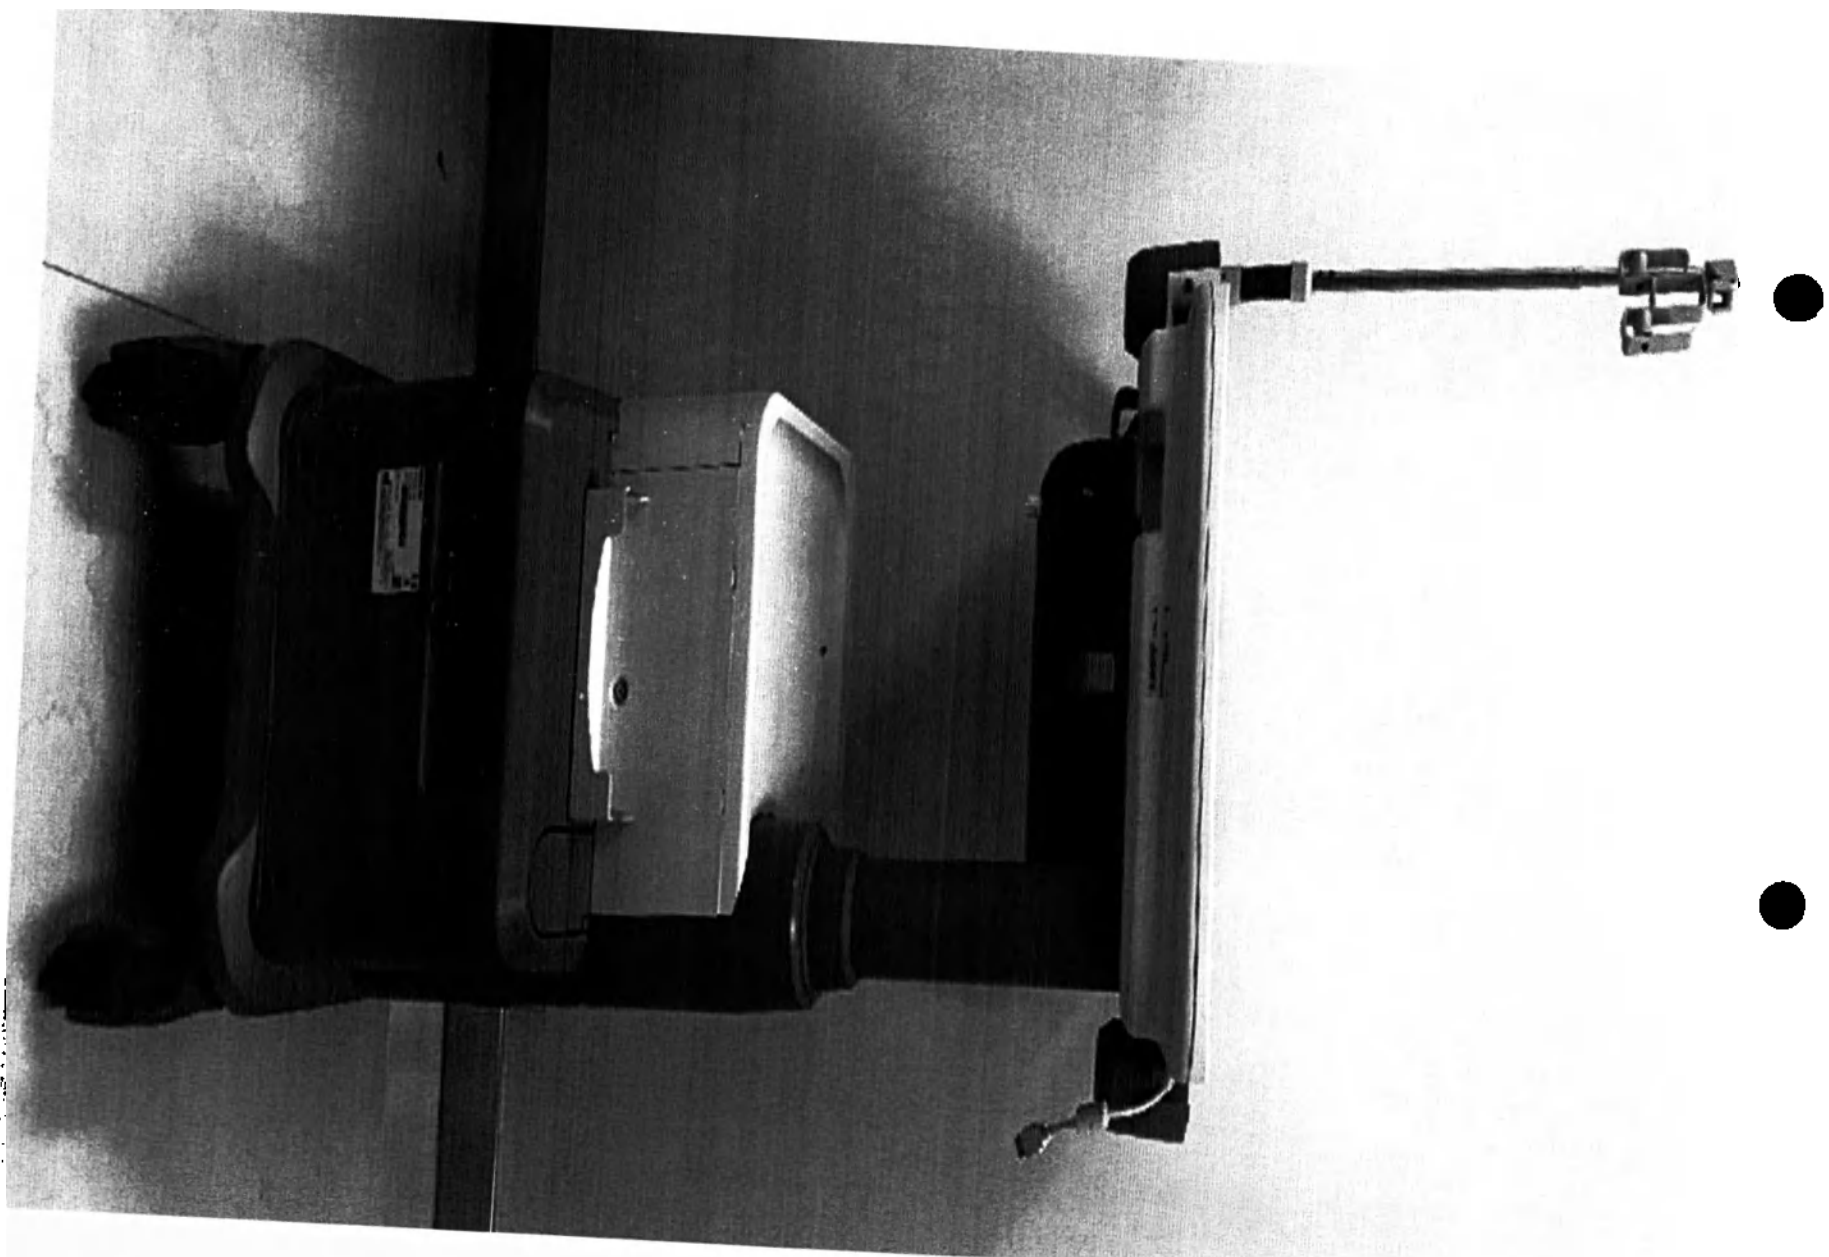


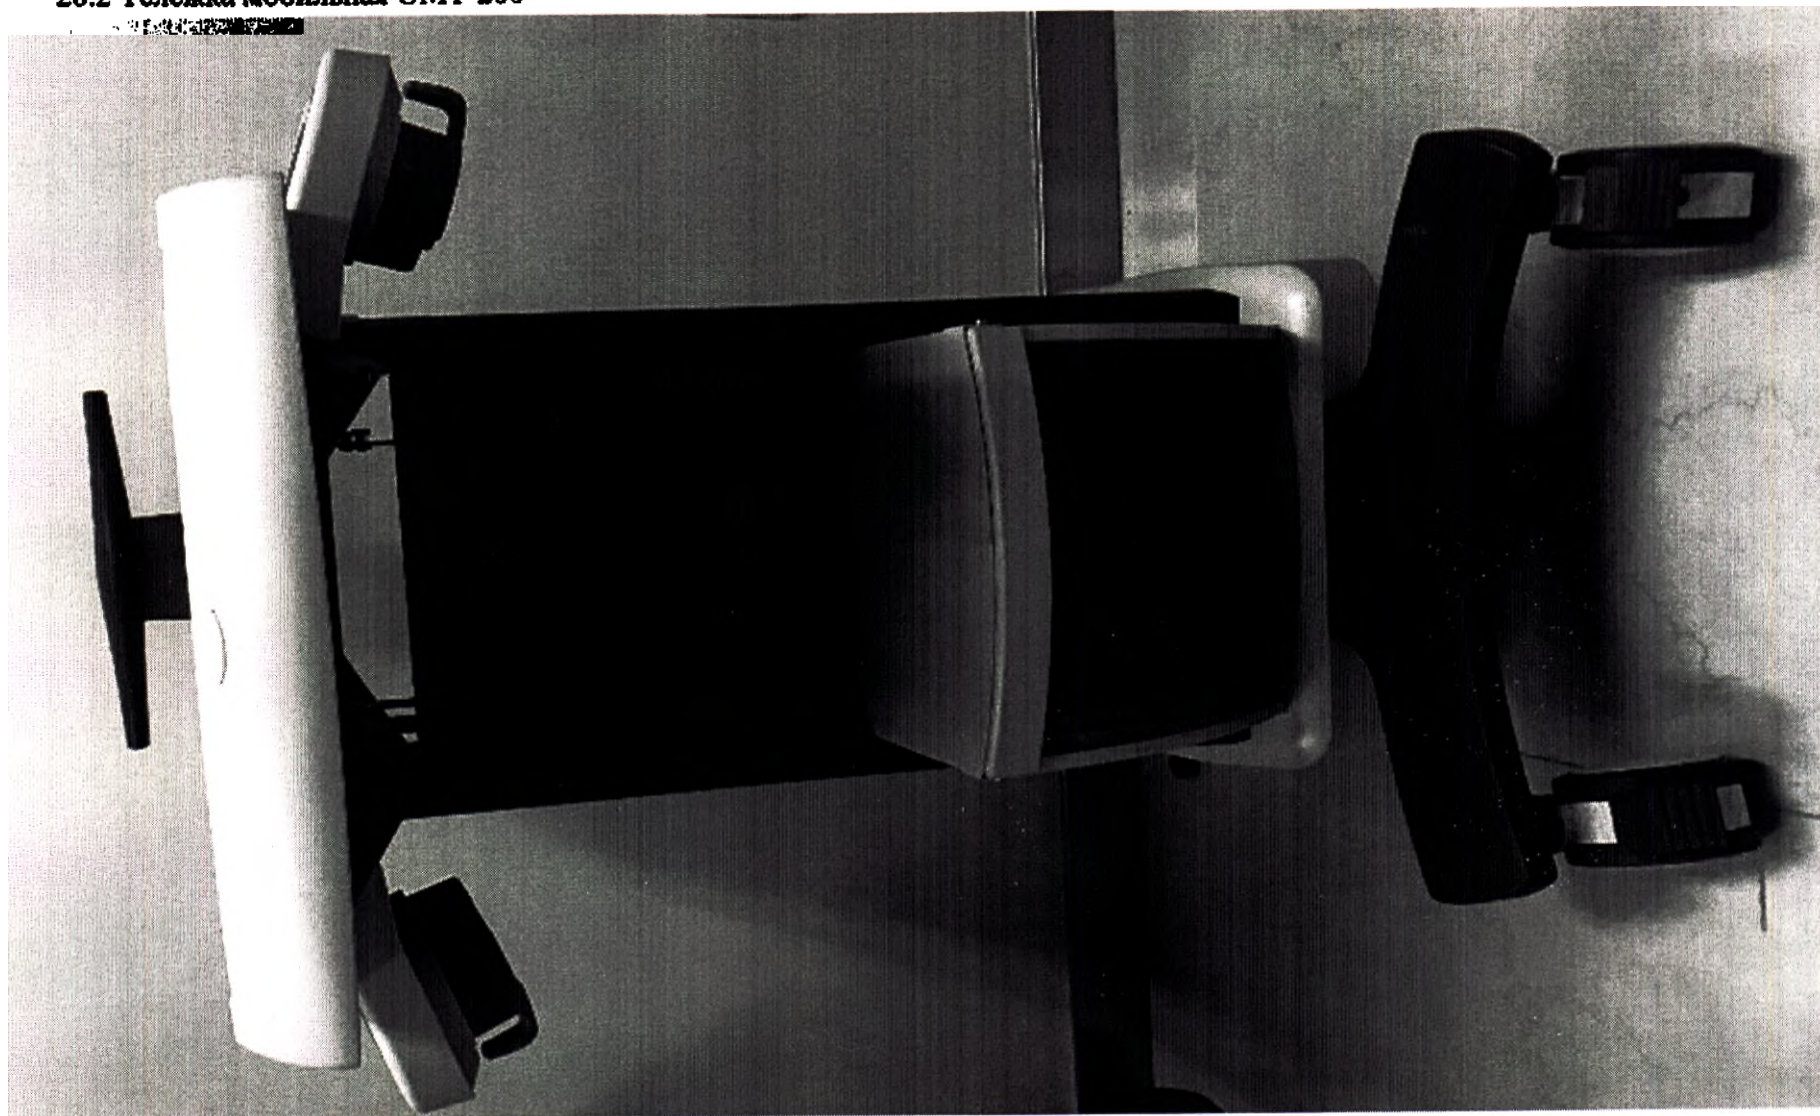

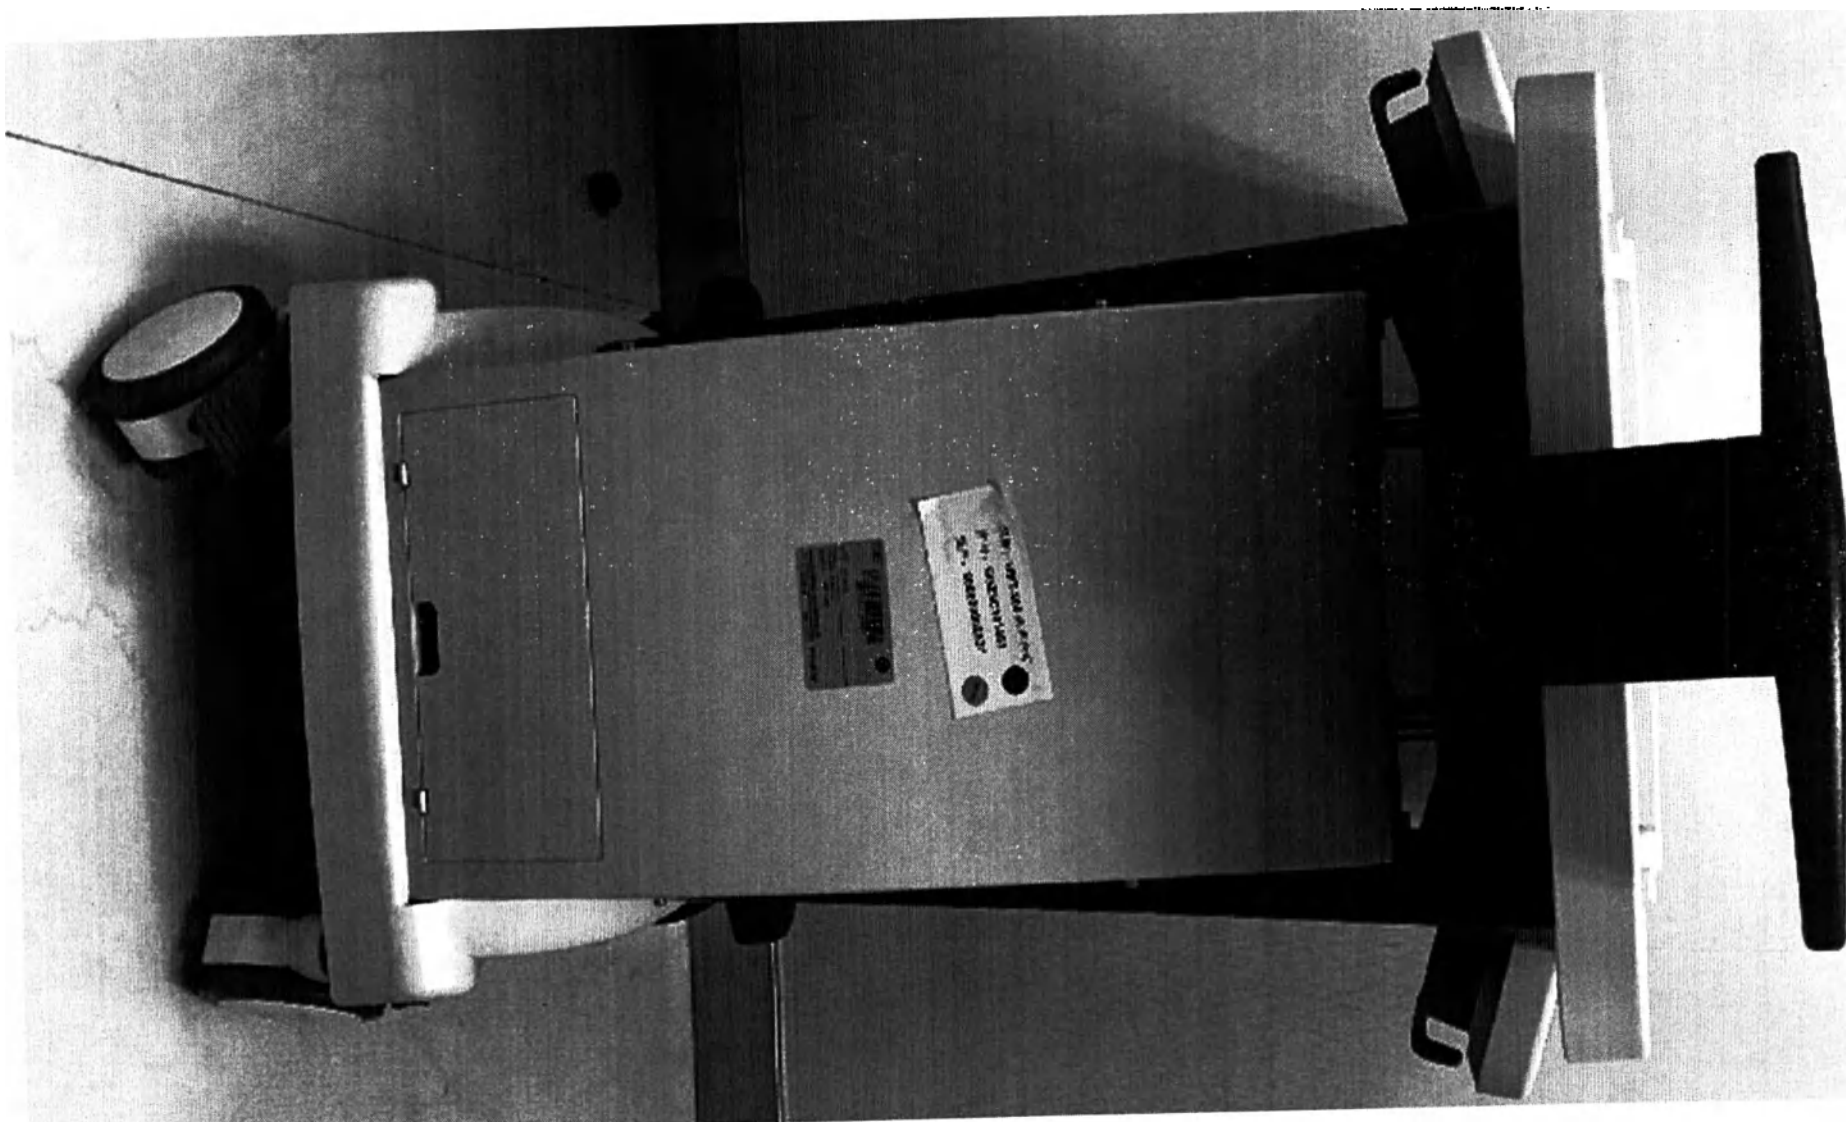

Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши

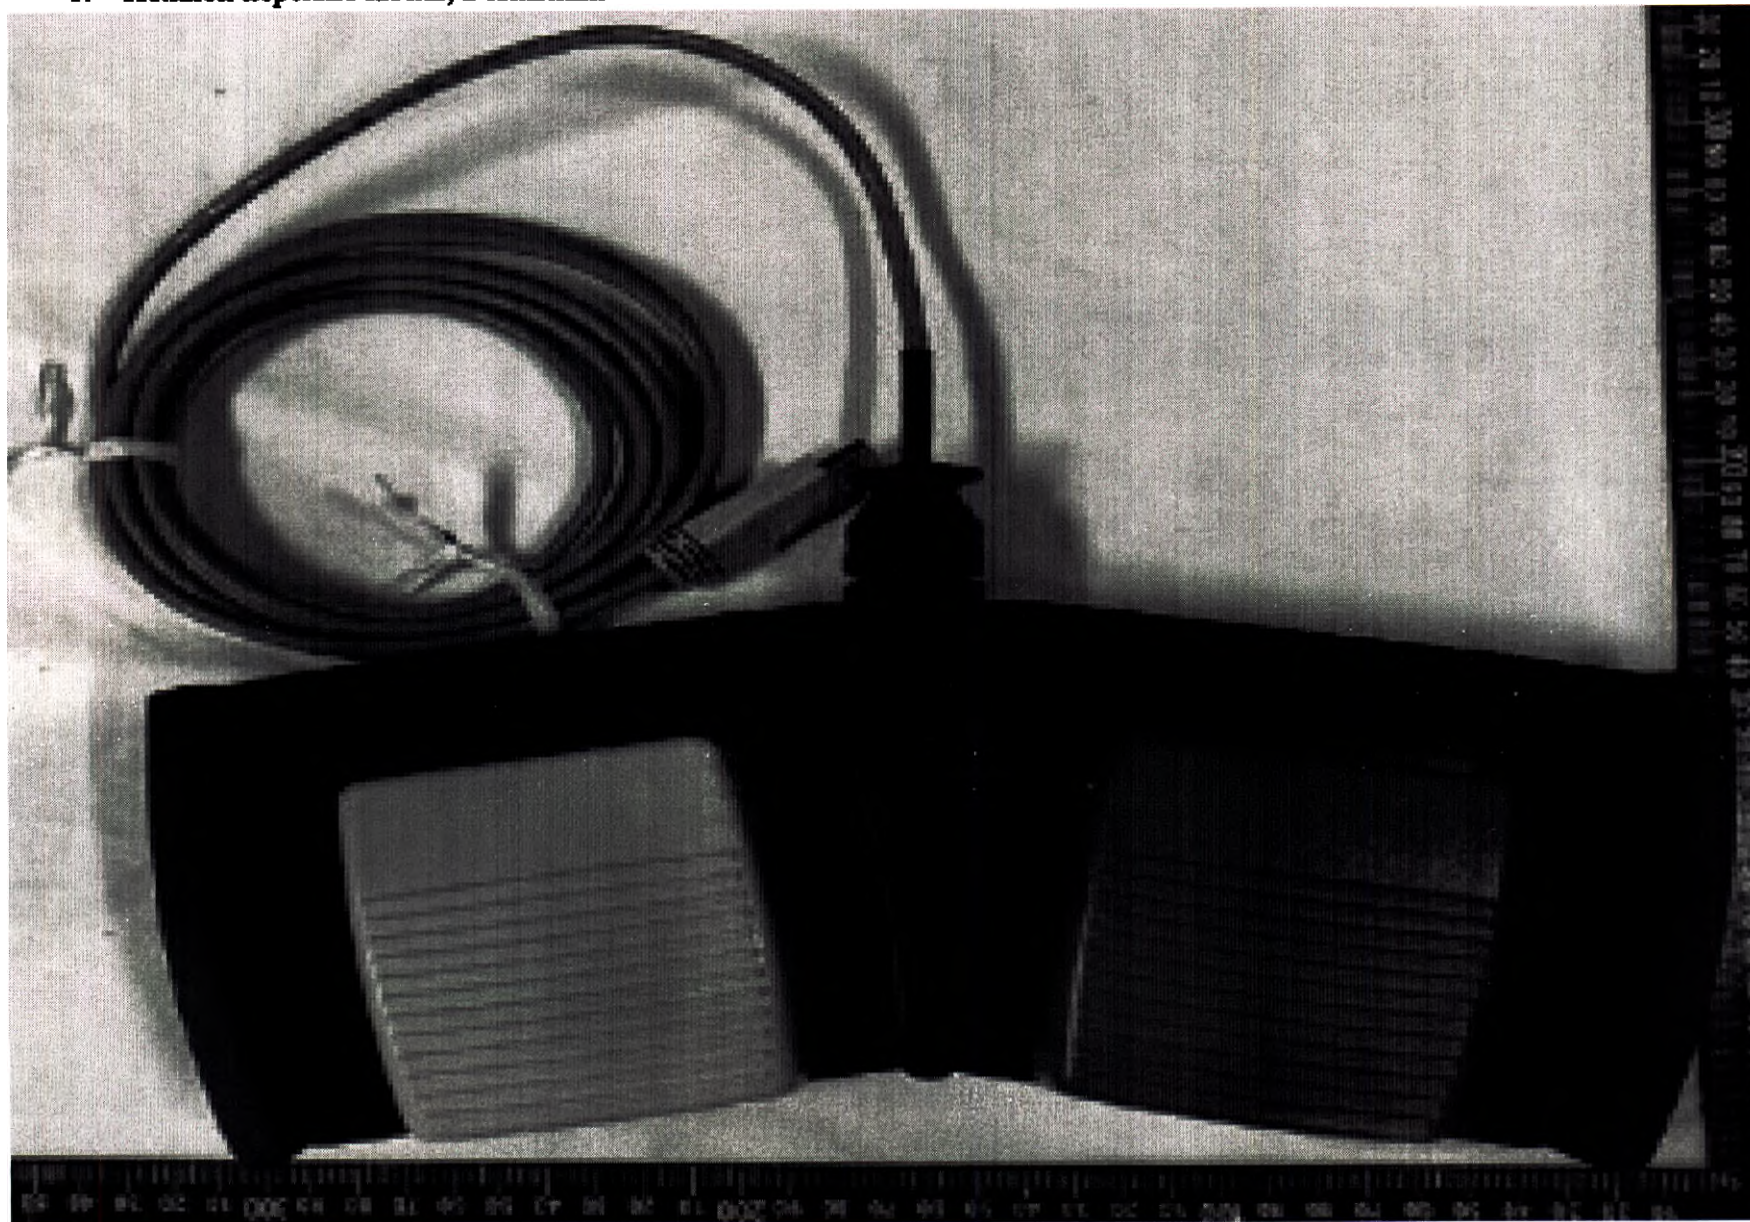



2.Ножной переключатель, 3 клавиши




III. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М6, в составе:

I. Основной блок М6

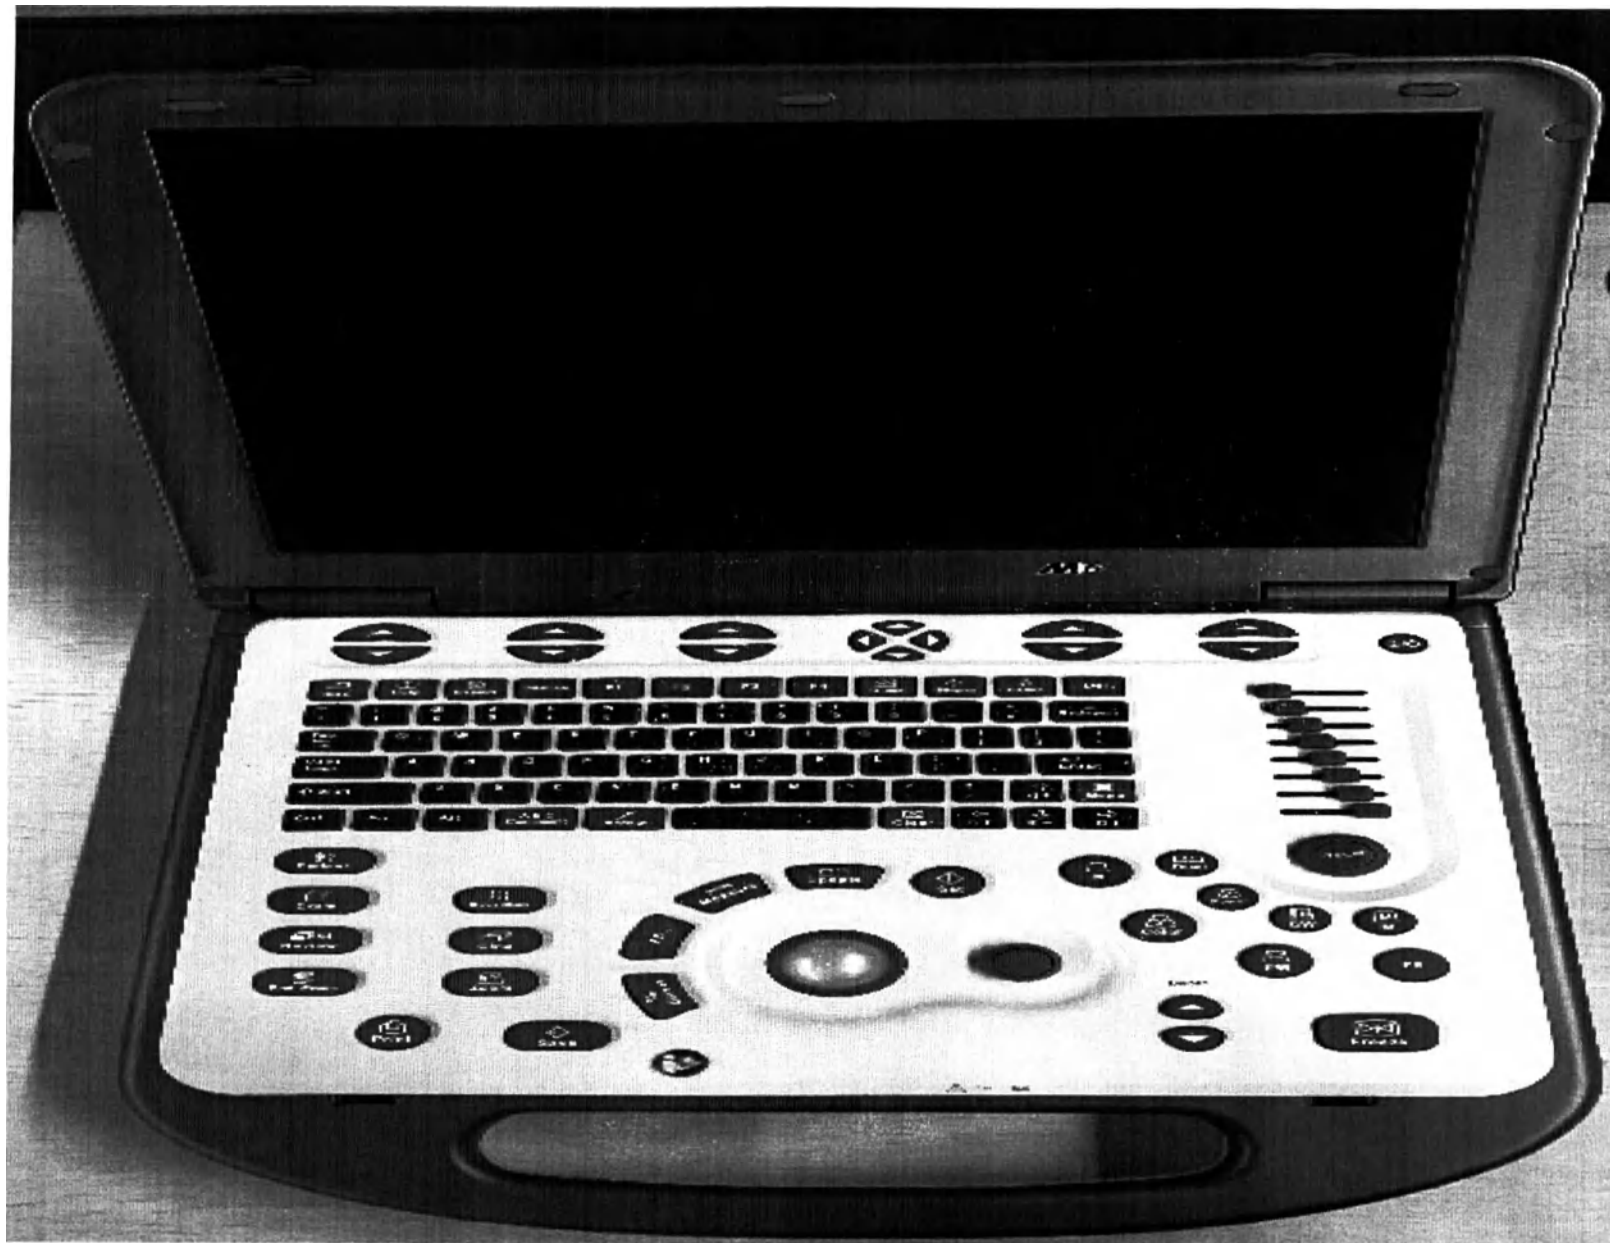


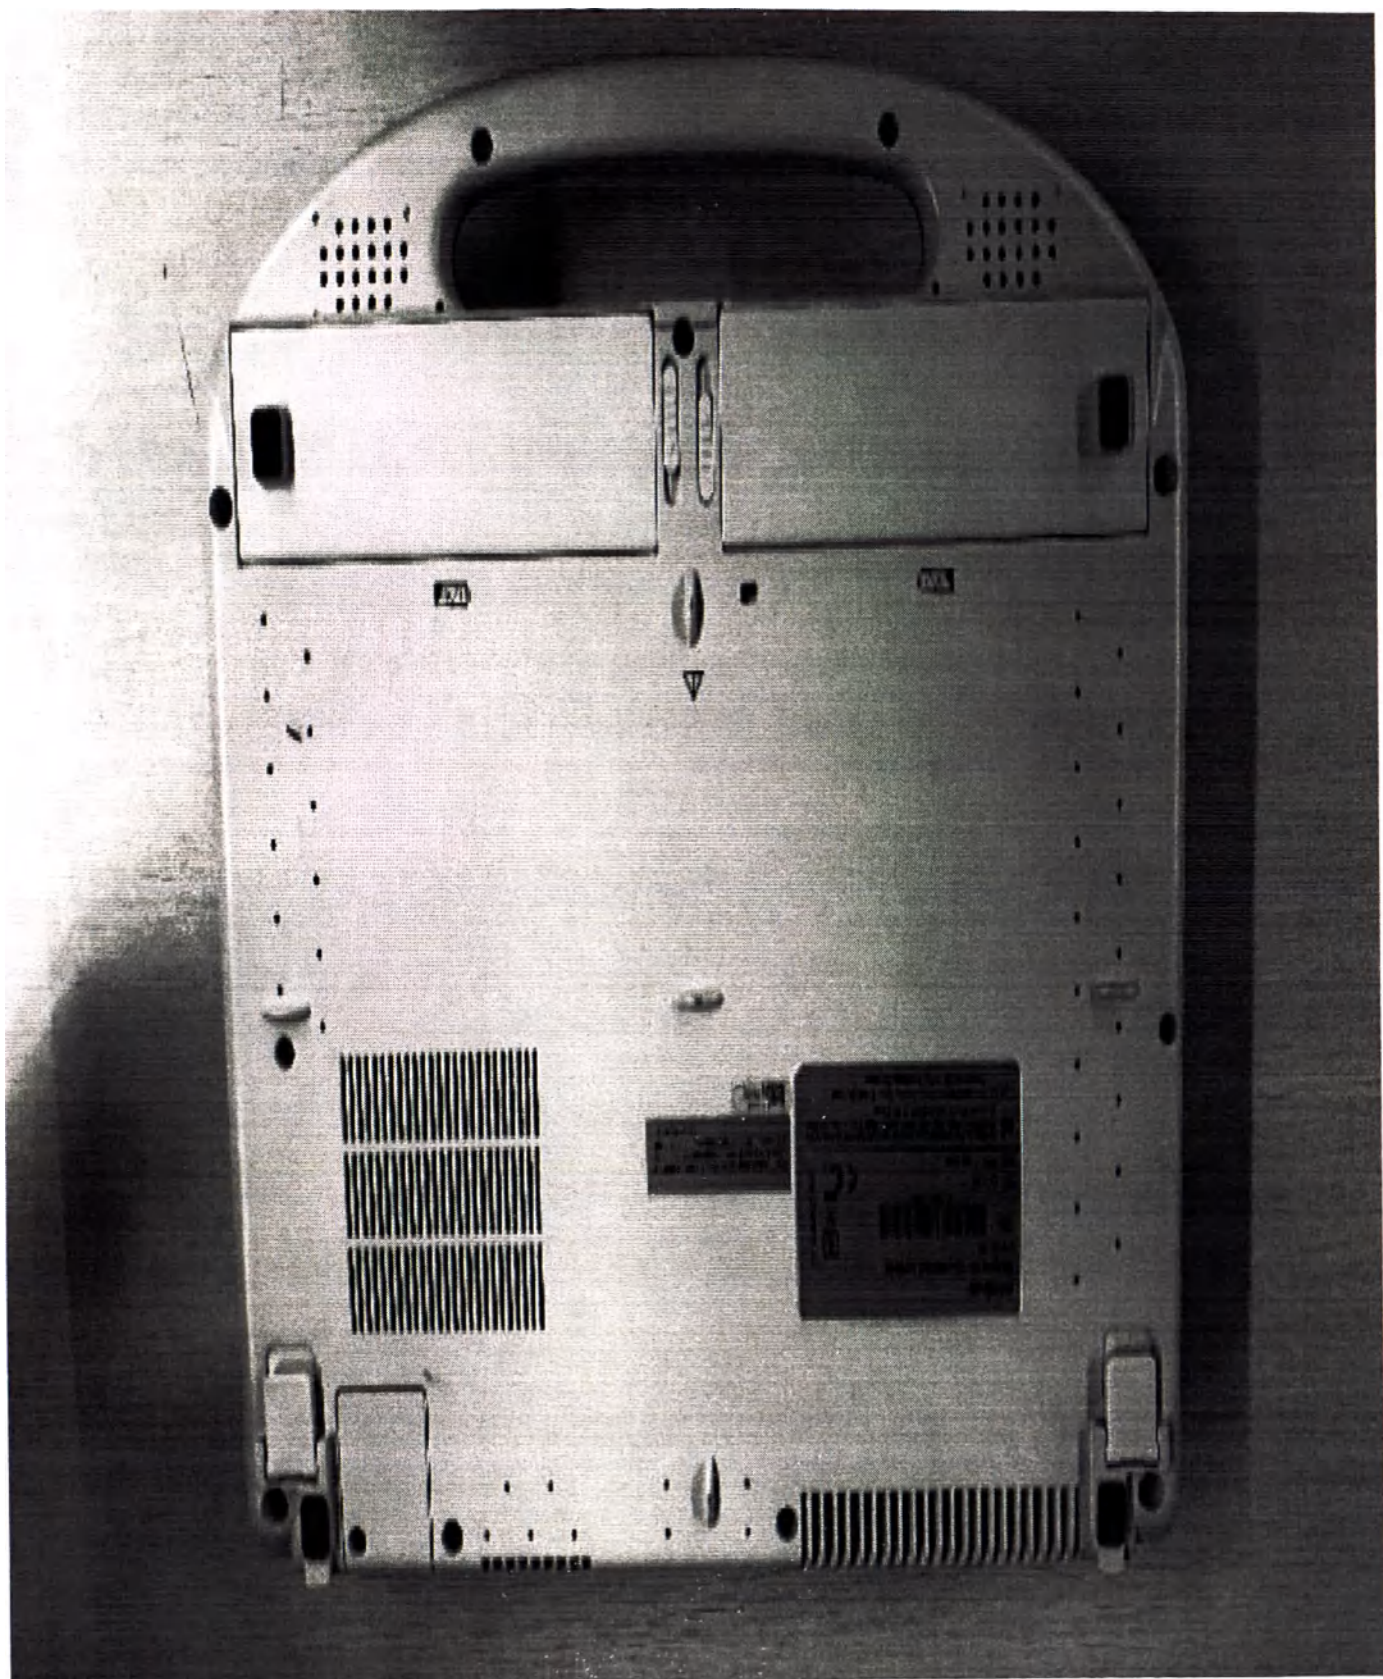


2. Руководство по эксплуатации

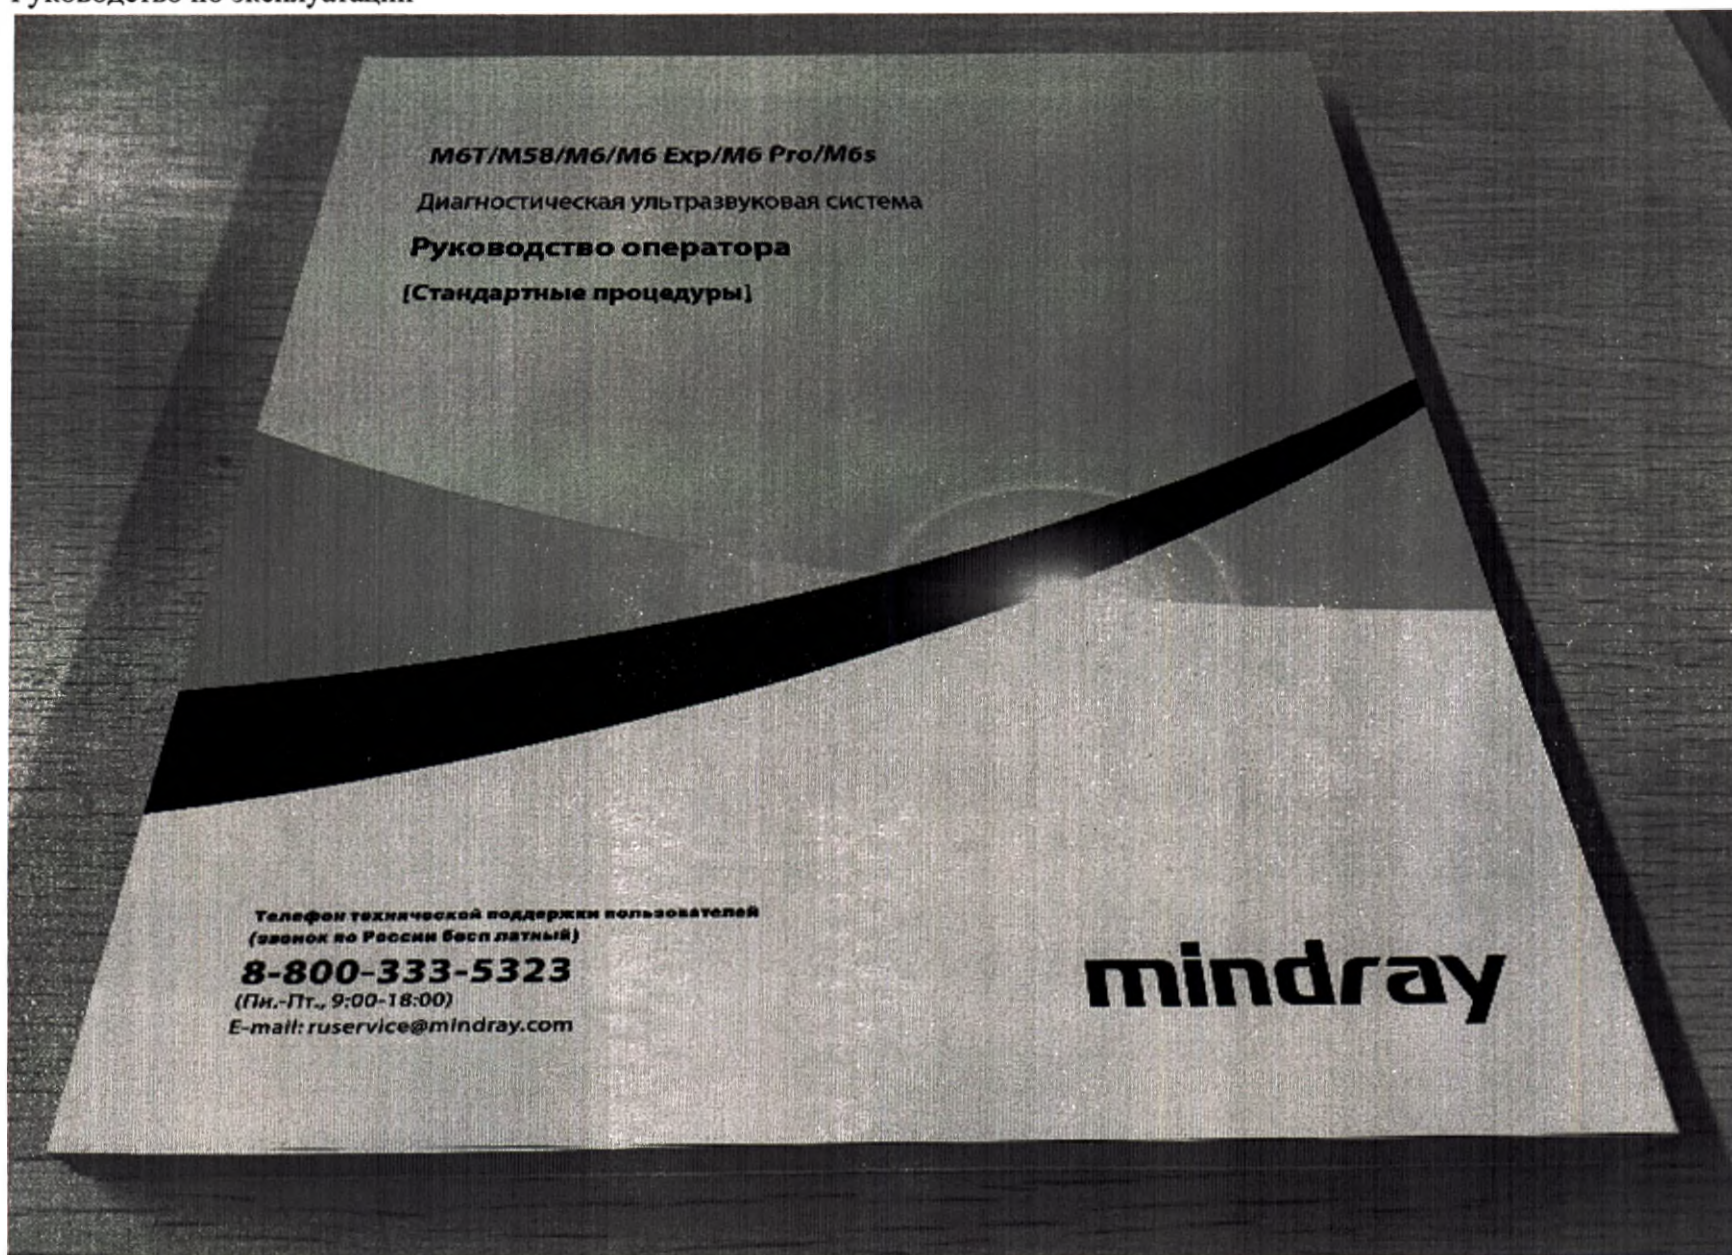

4. Кабель питания

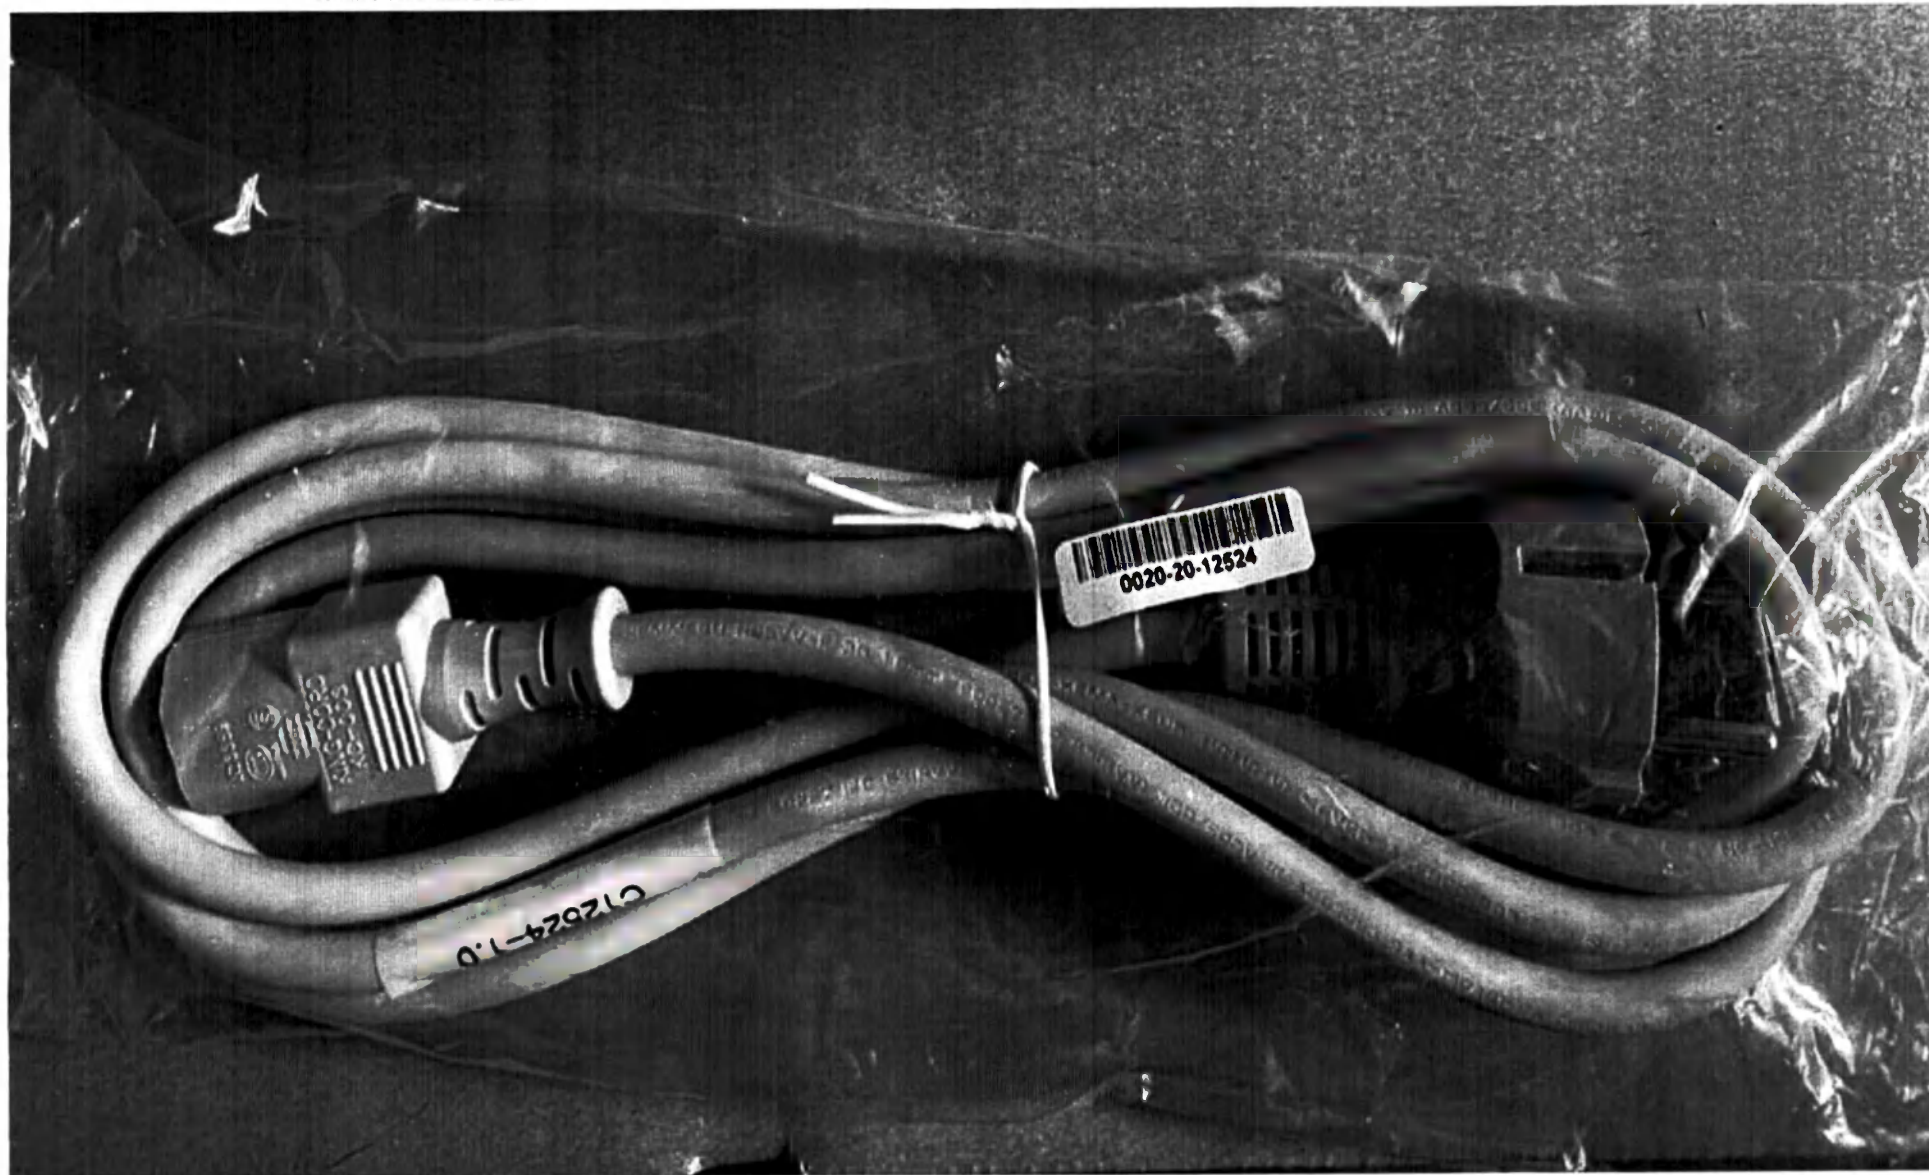

5. Накладка на панель управления(русифицированная)

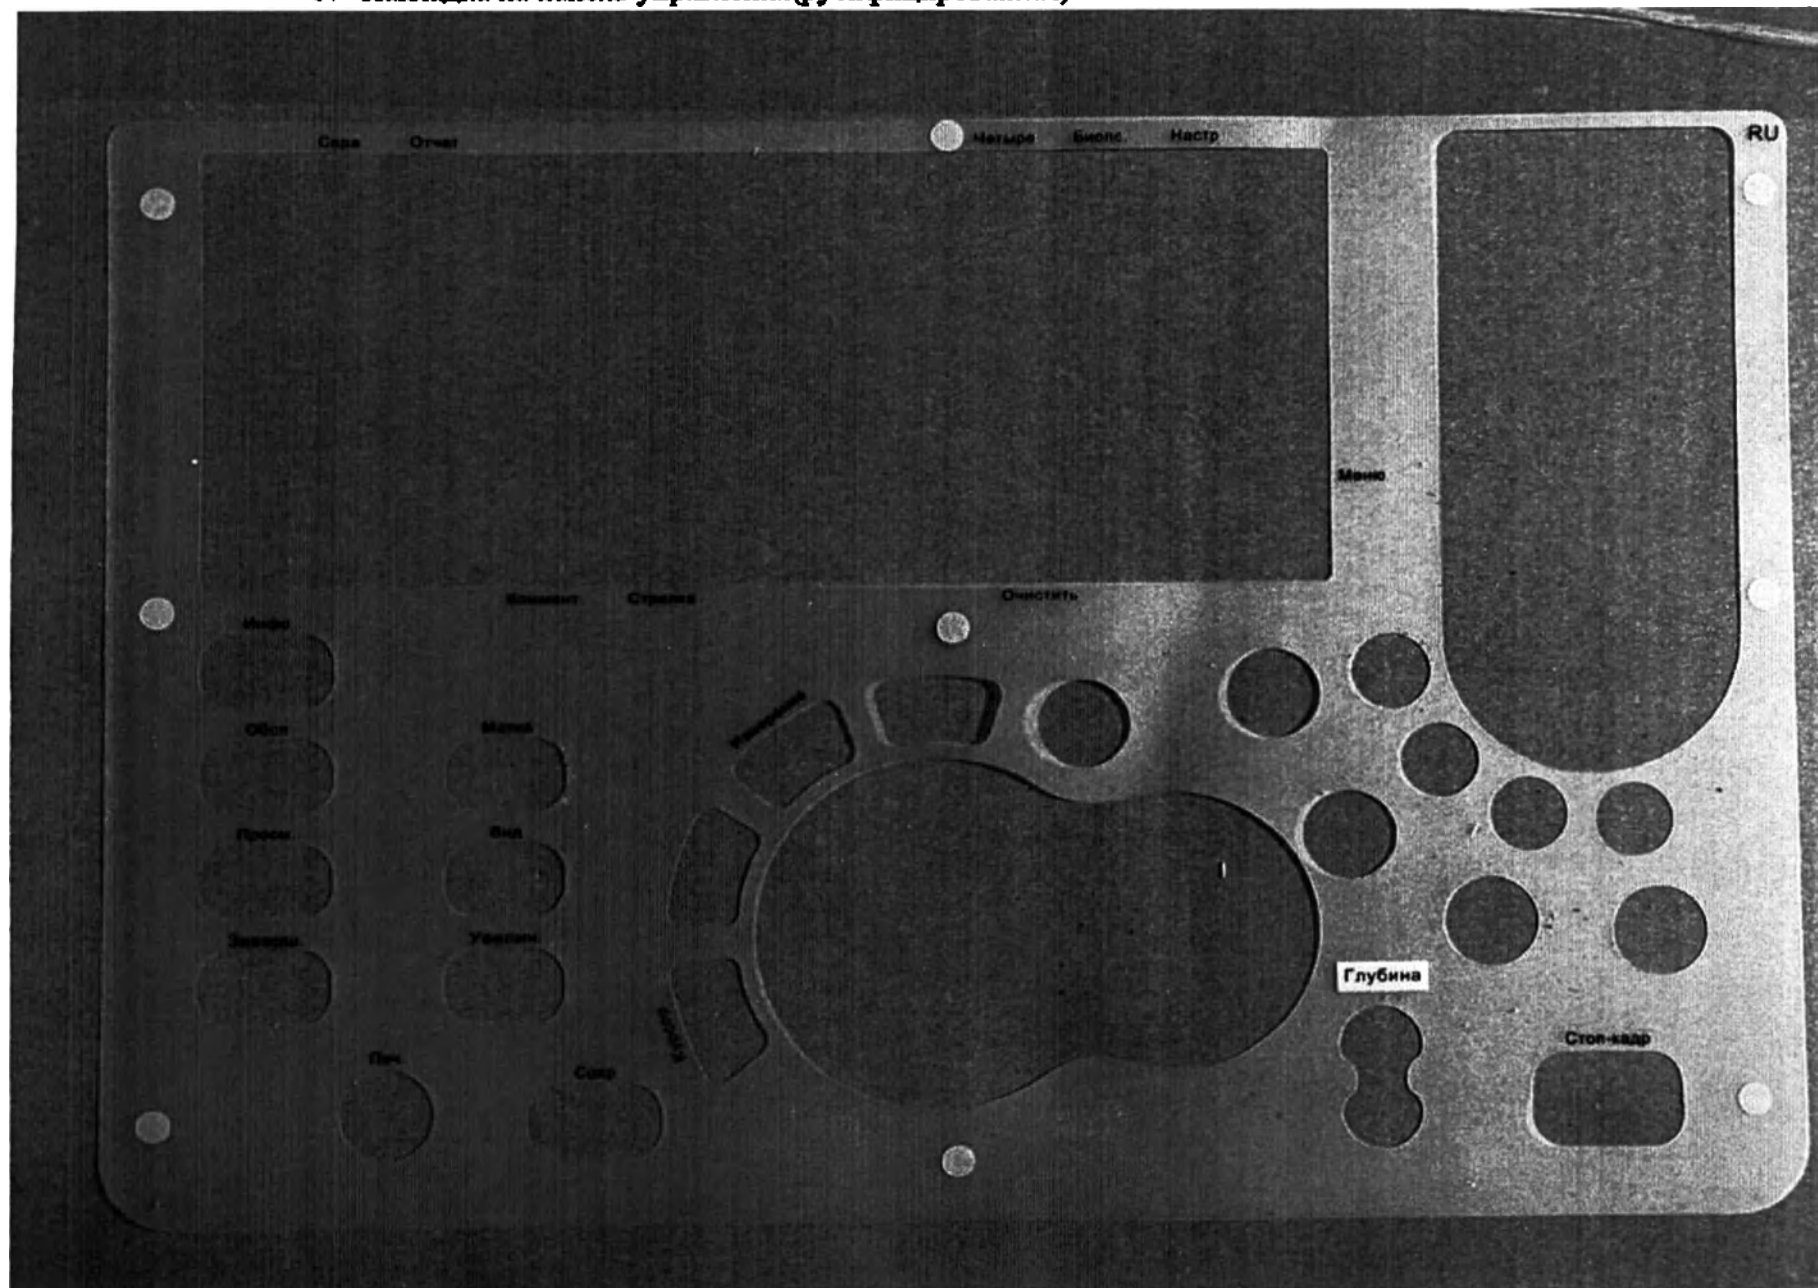


6. Адаптер питания







8. Разветвитель для датчиков

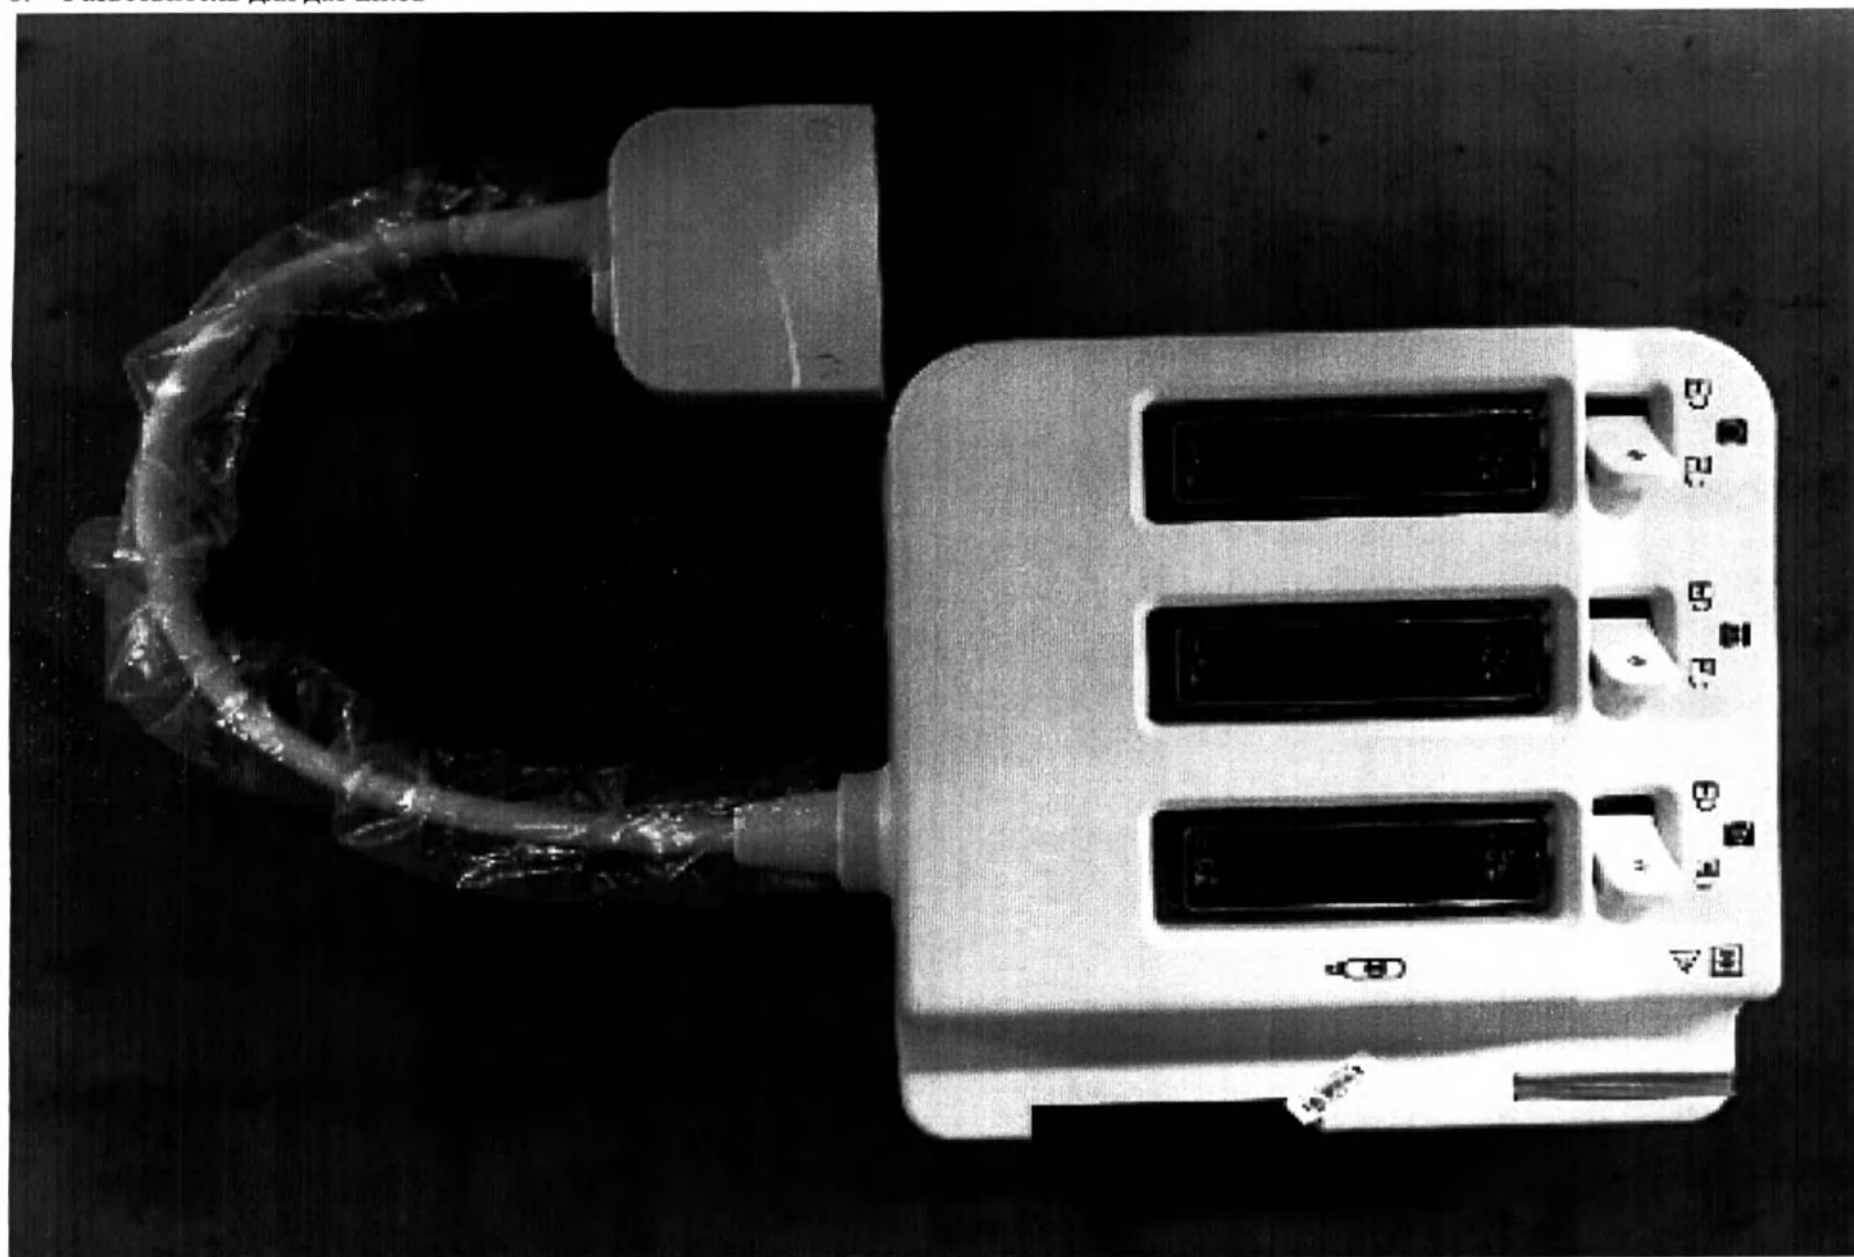


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

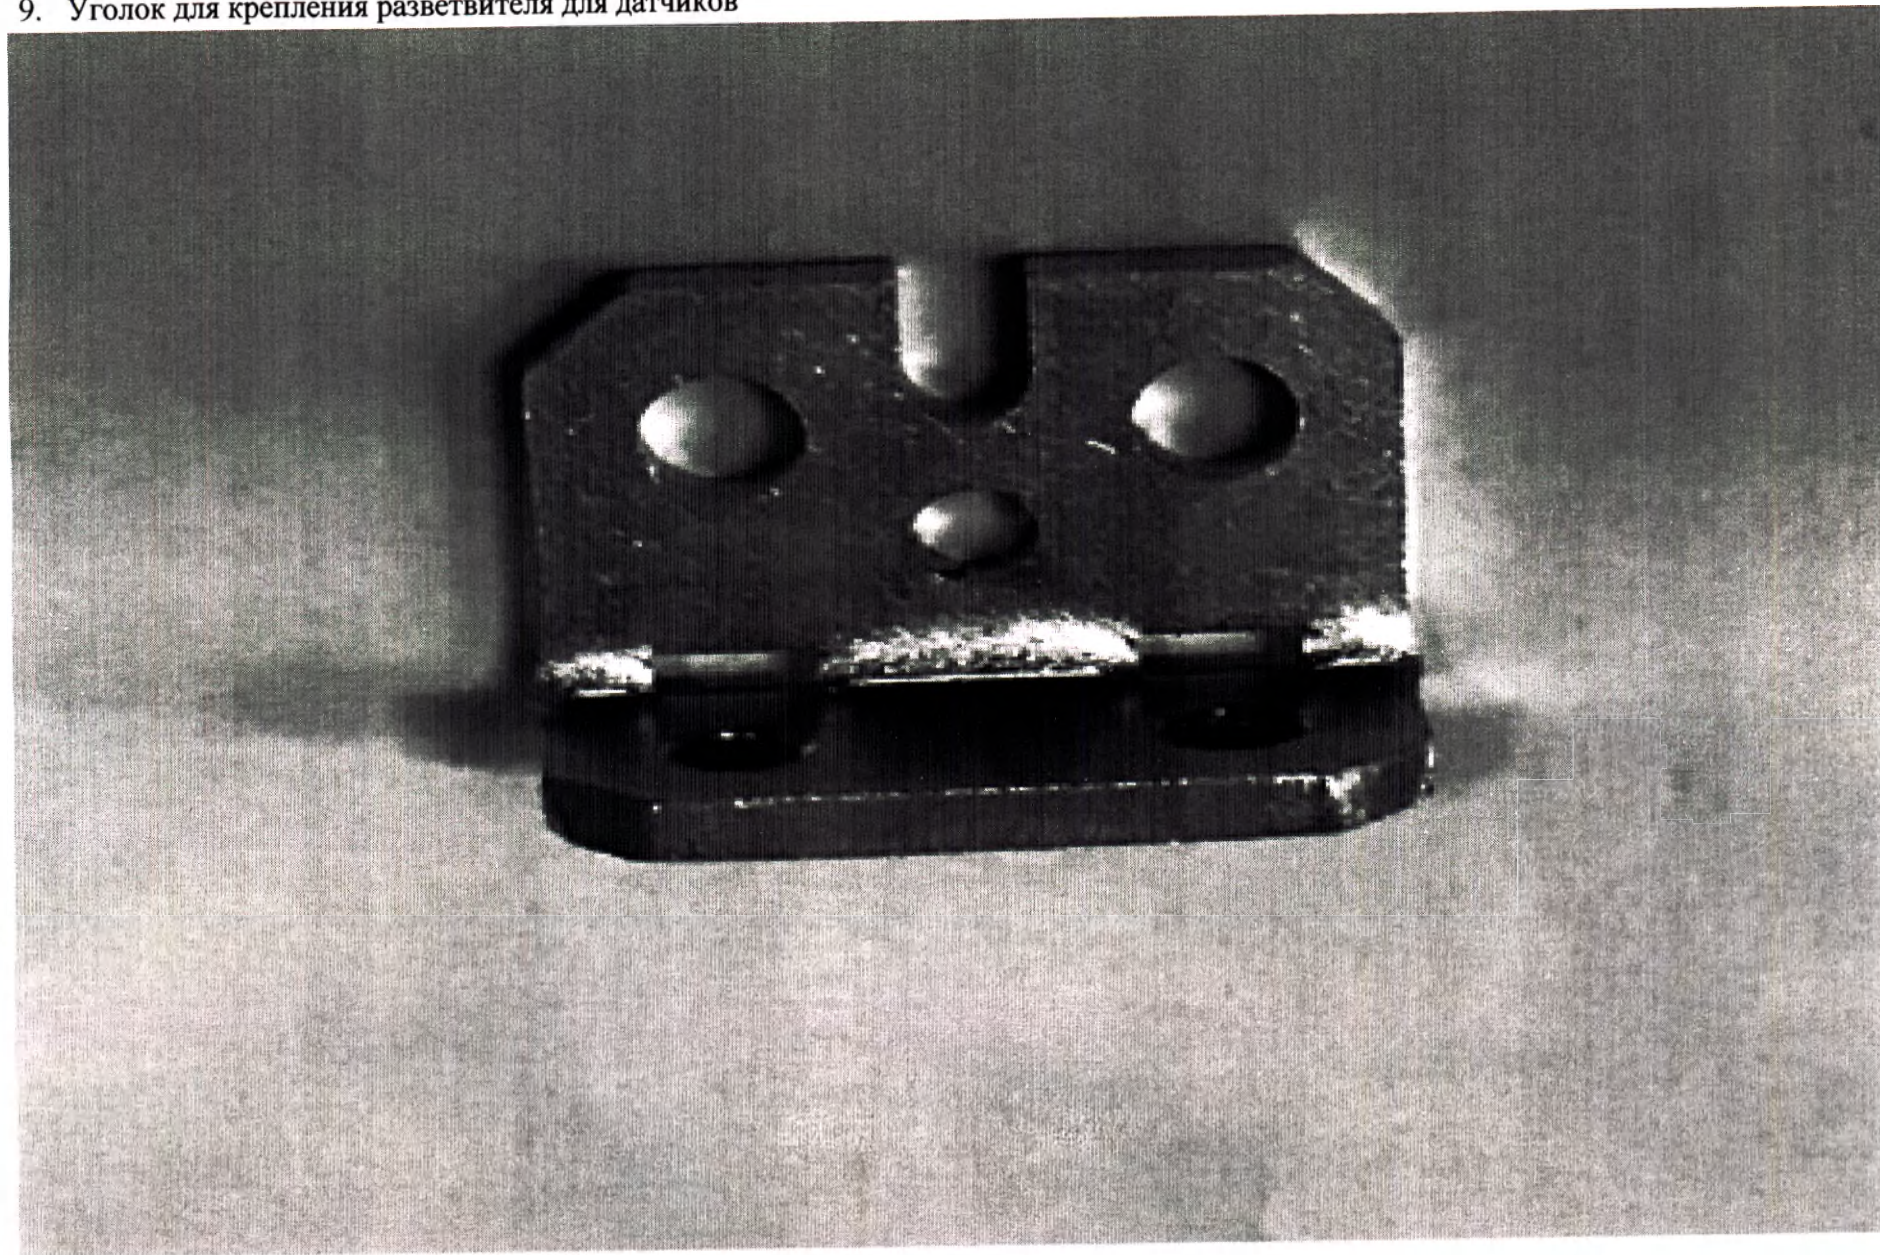

10. Заглушка порта датчика

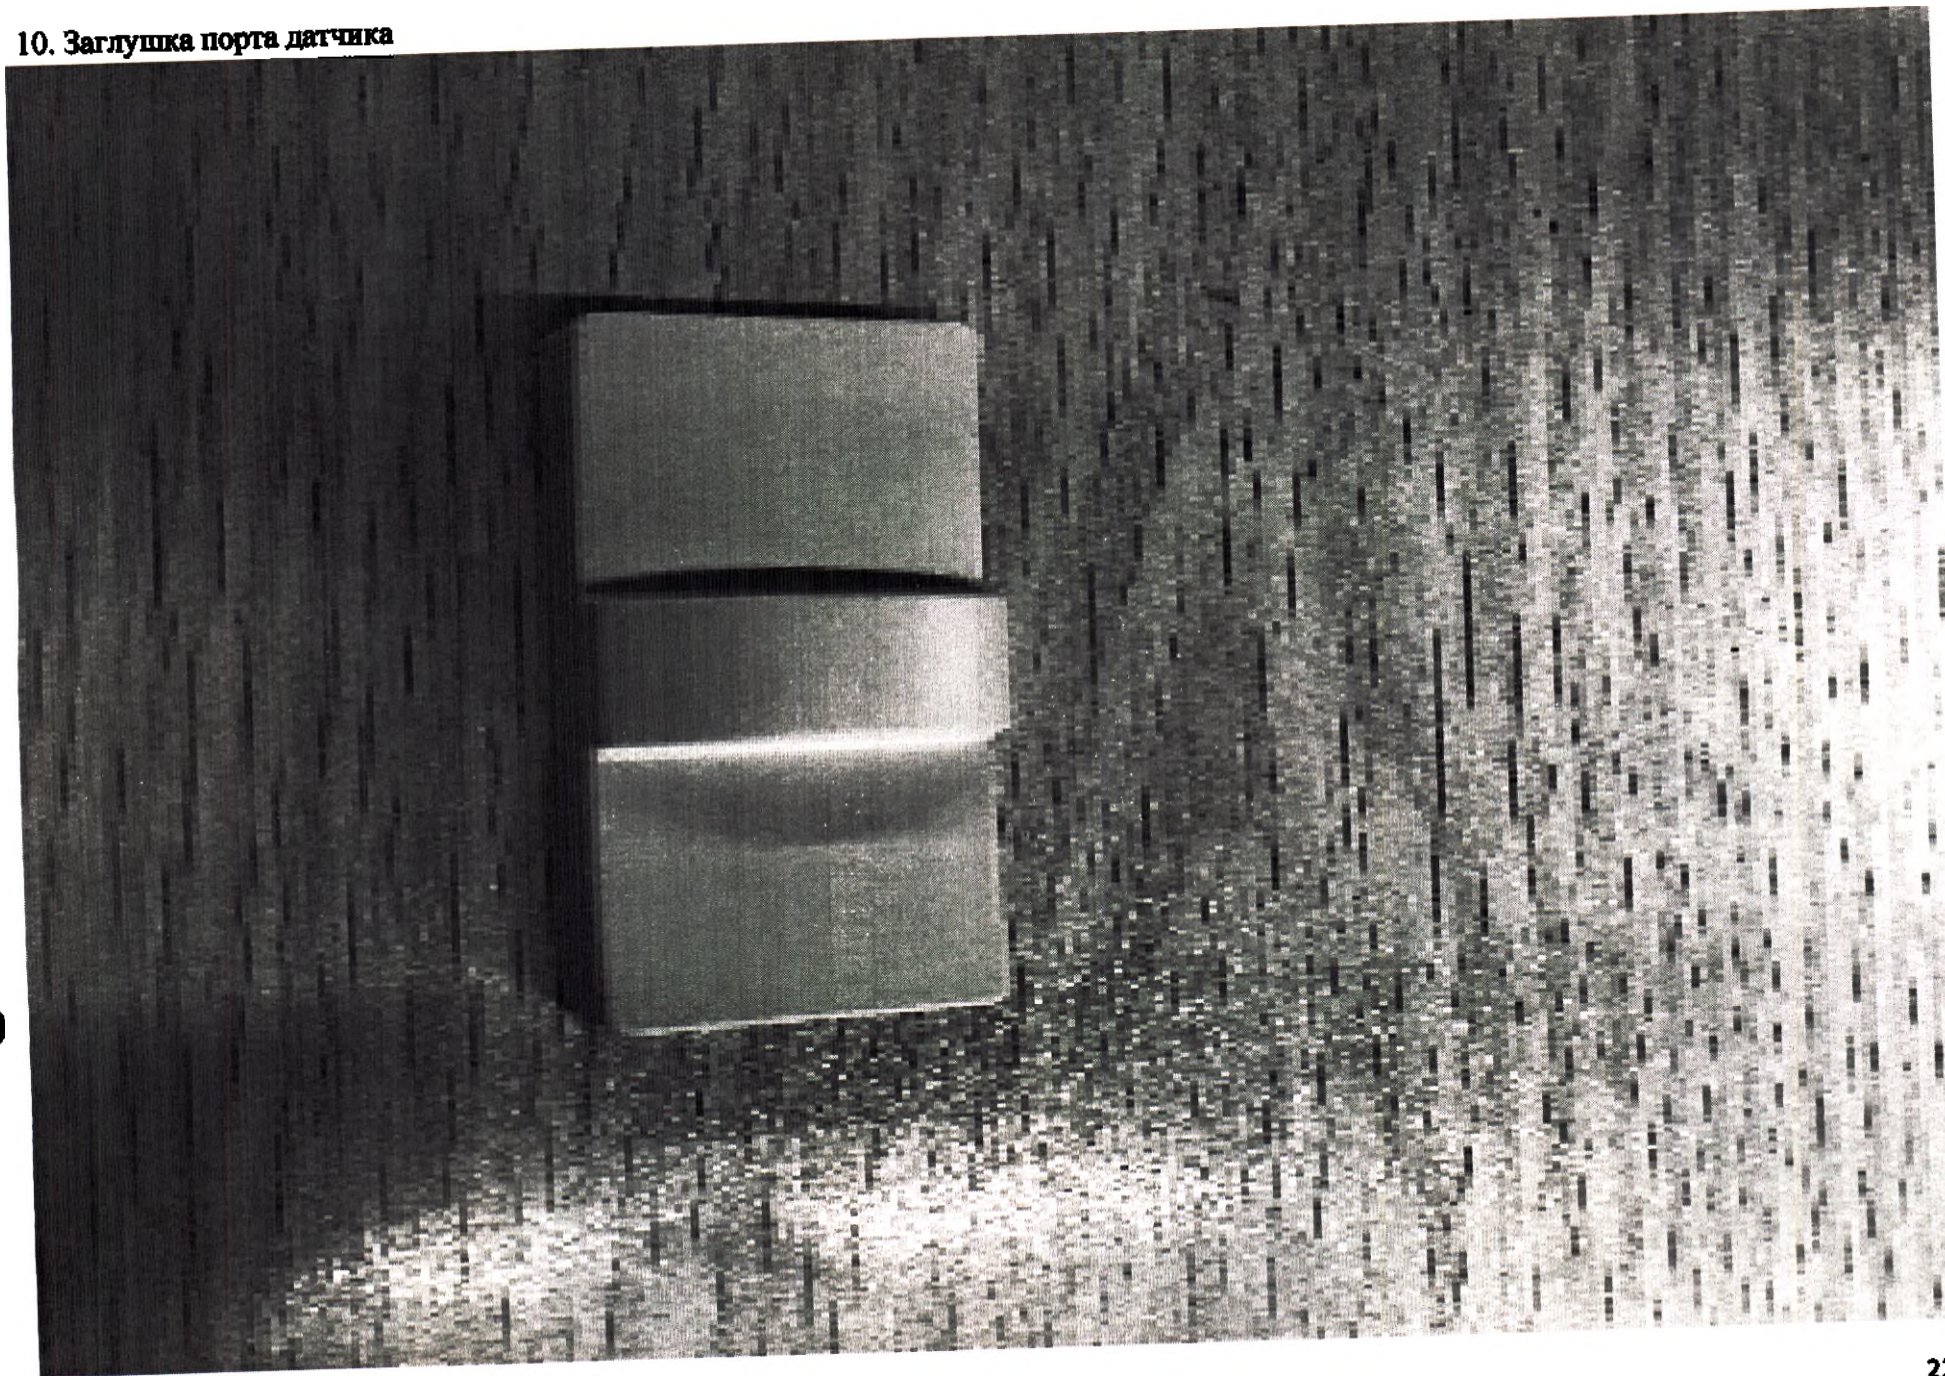

11. Шайба плоская

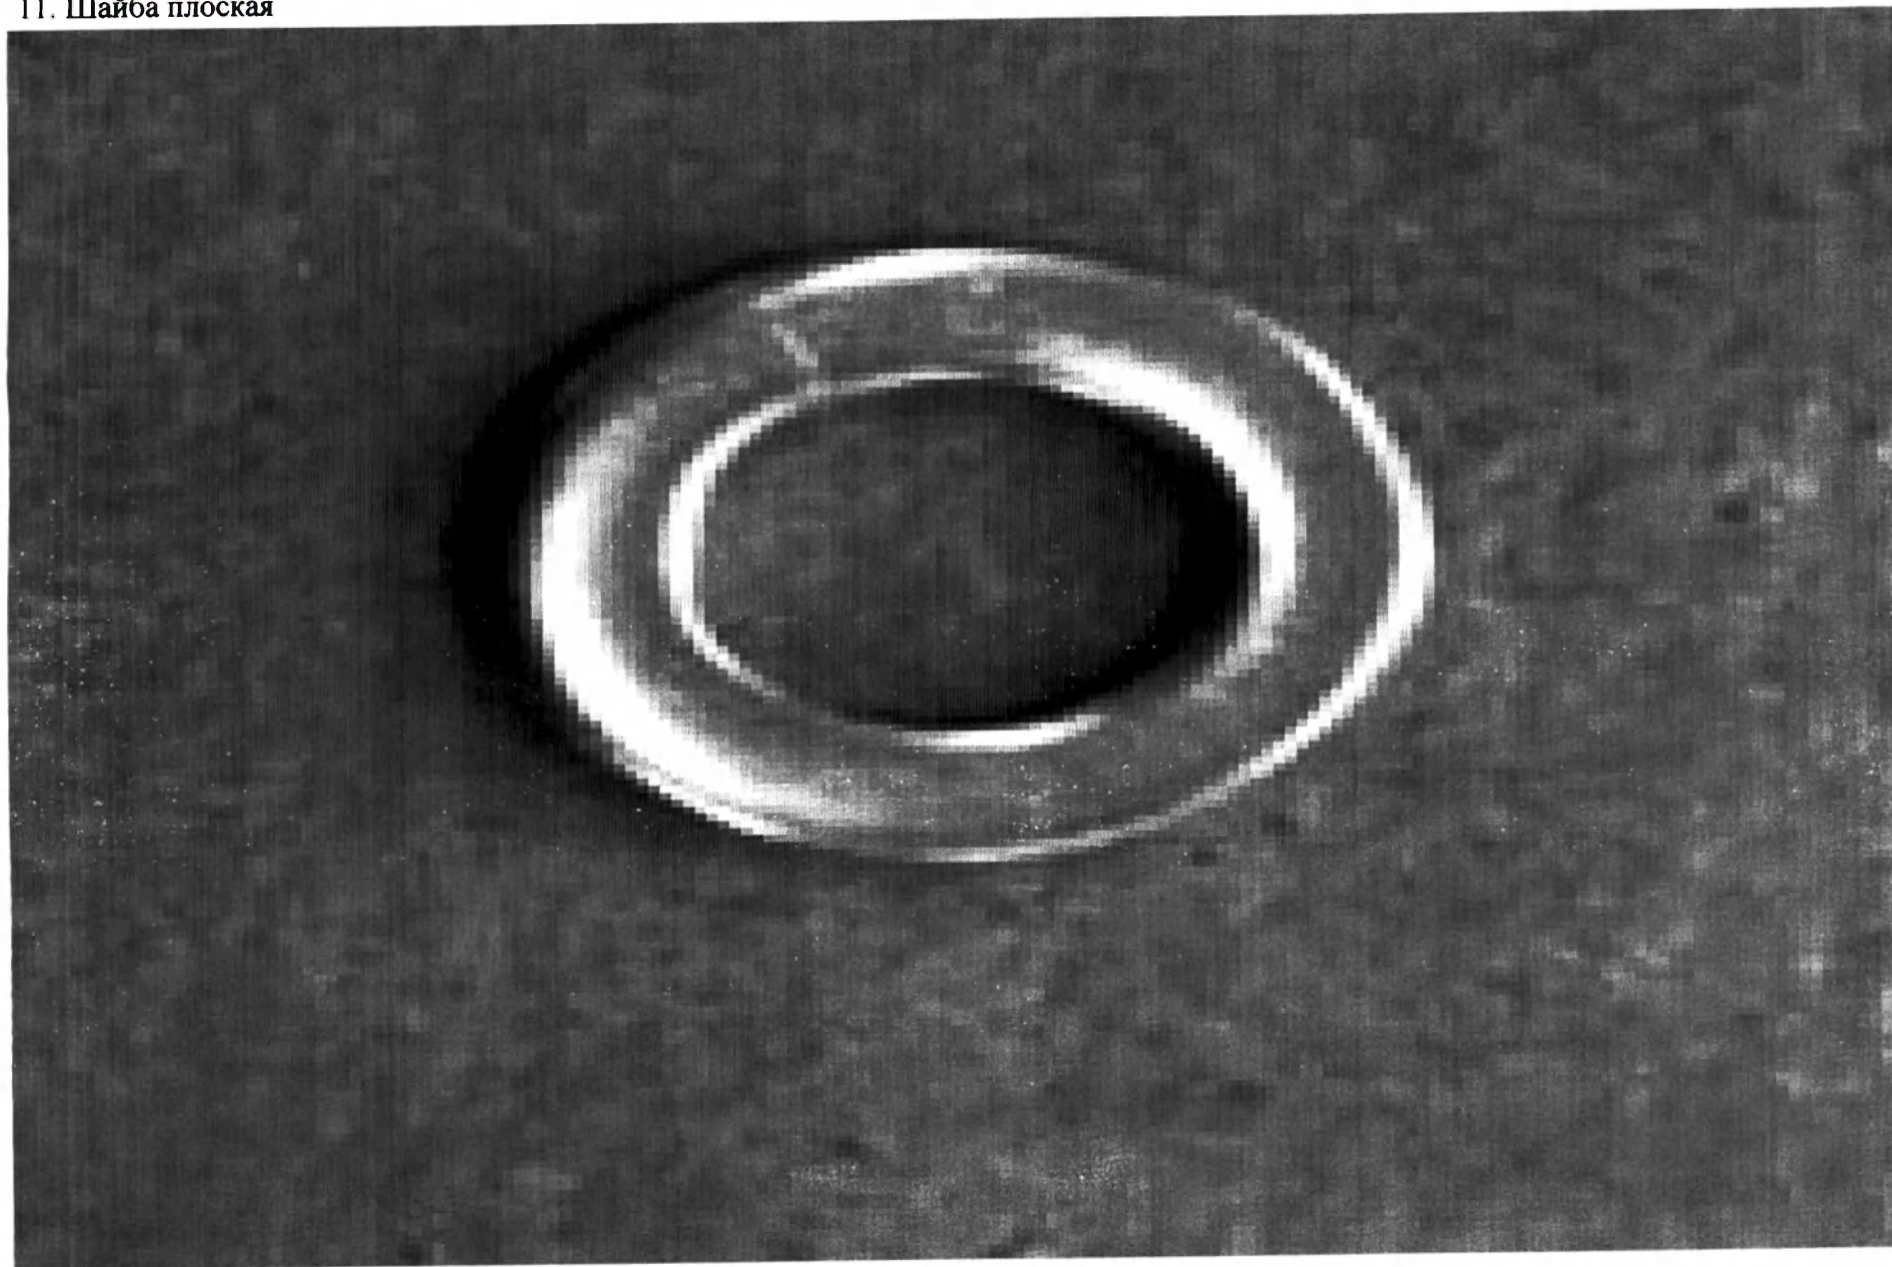


12. Шайба гроверная (пружинная)



13. Винт с головкой под шестигранный ключ




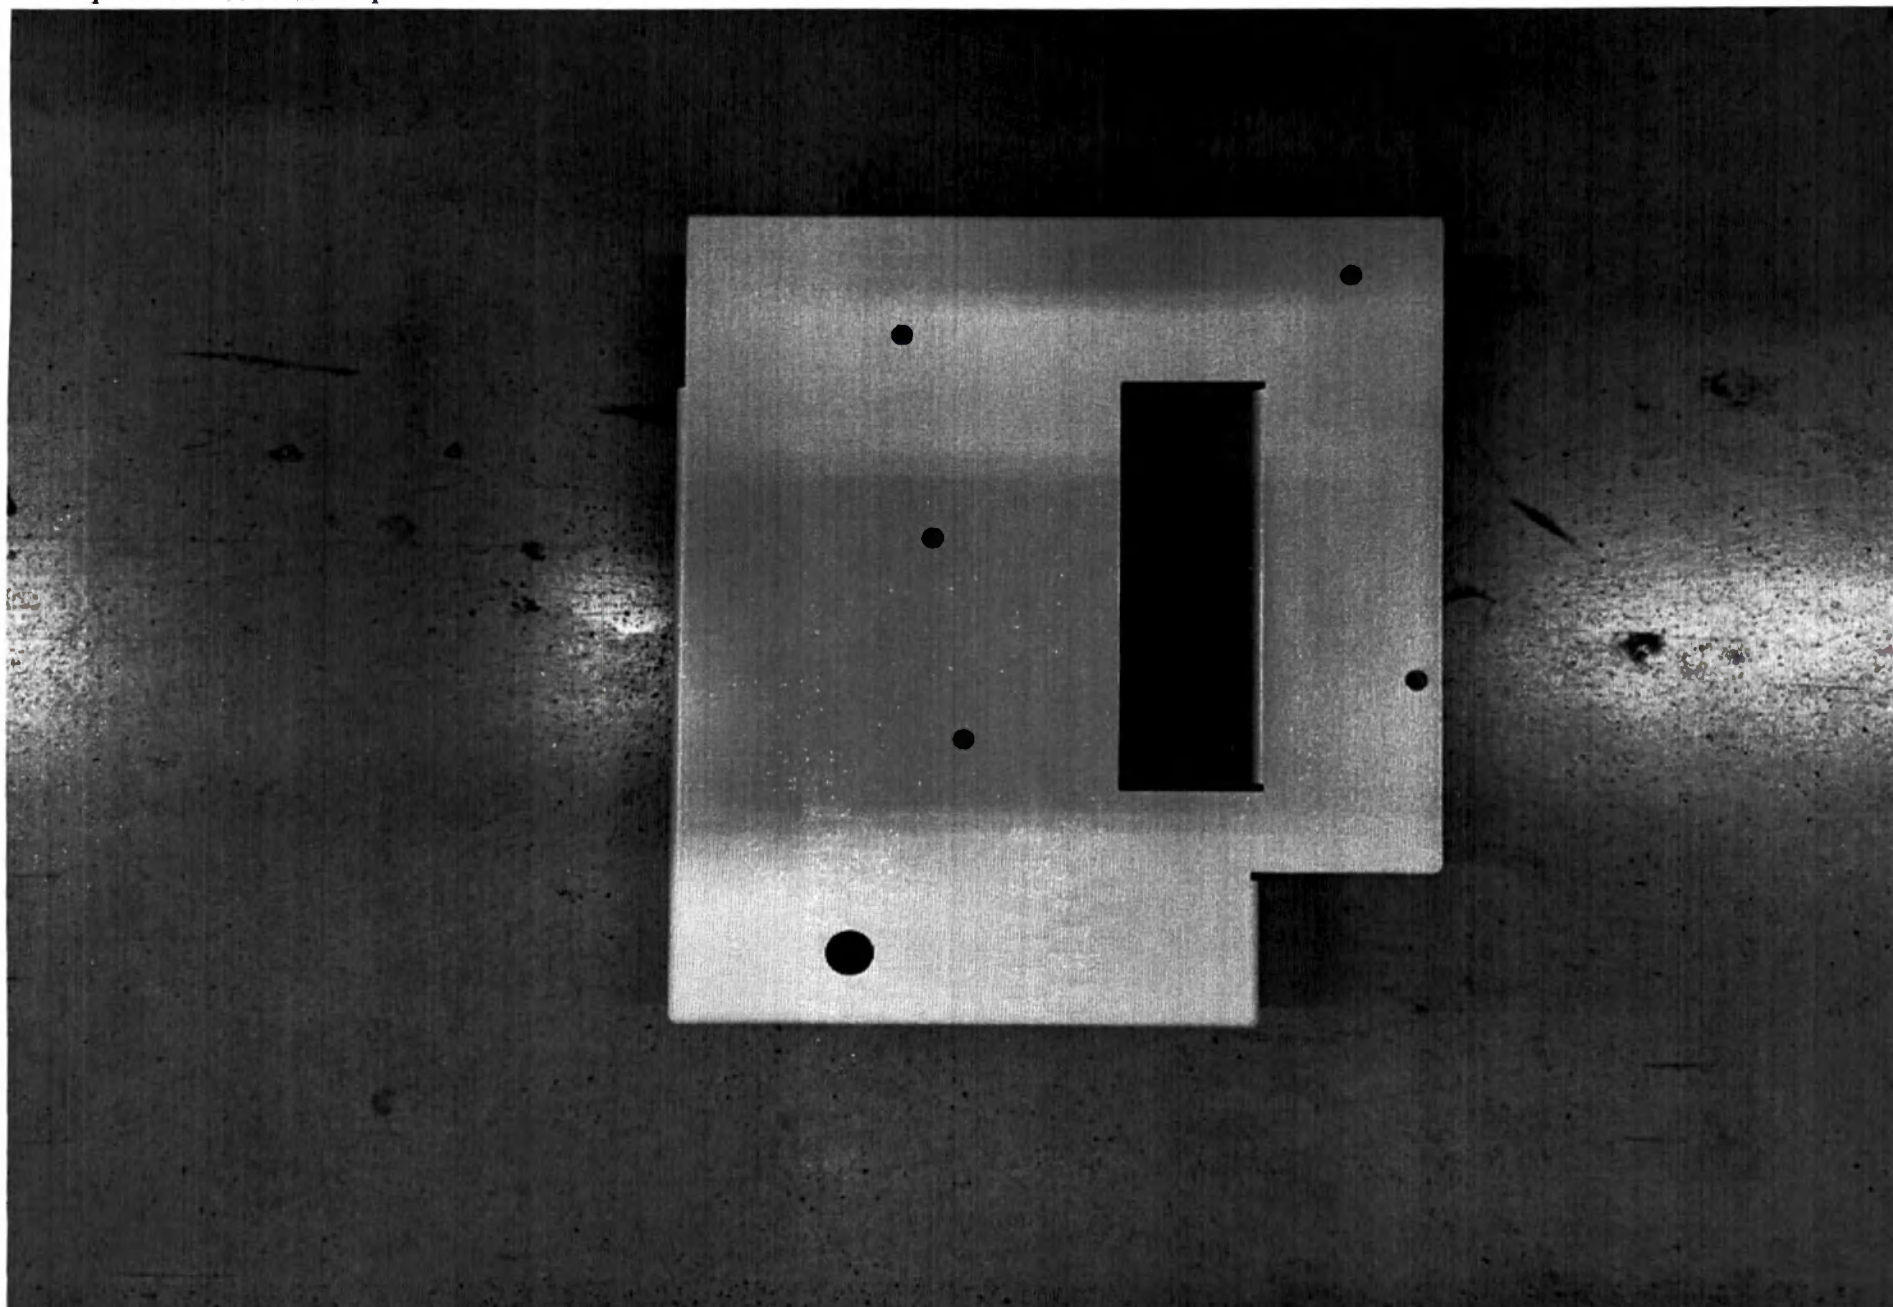


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку



16. Беспроводной USB-адаптер

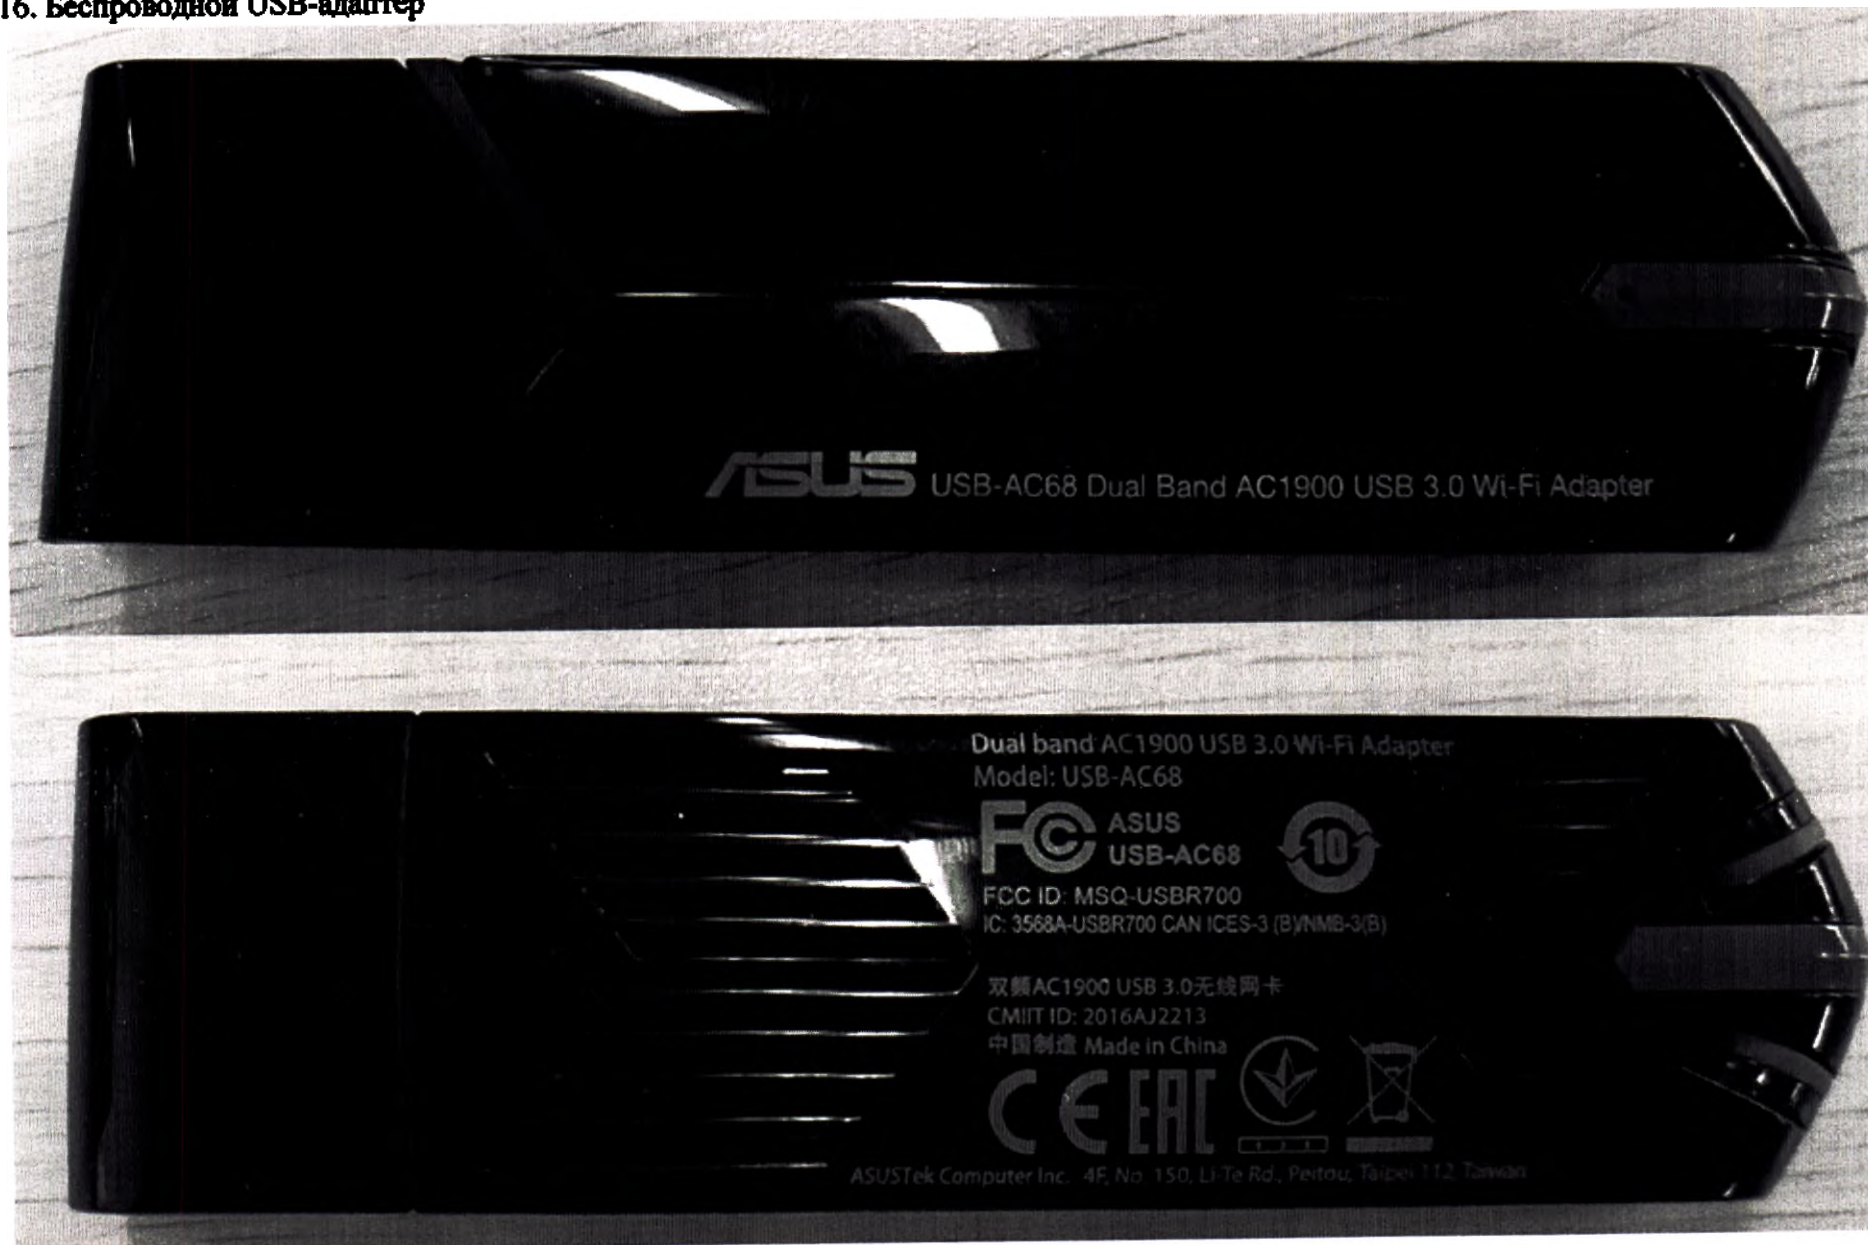


17. Модуль расширения портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов

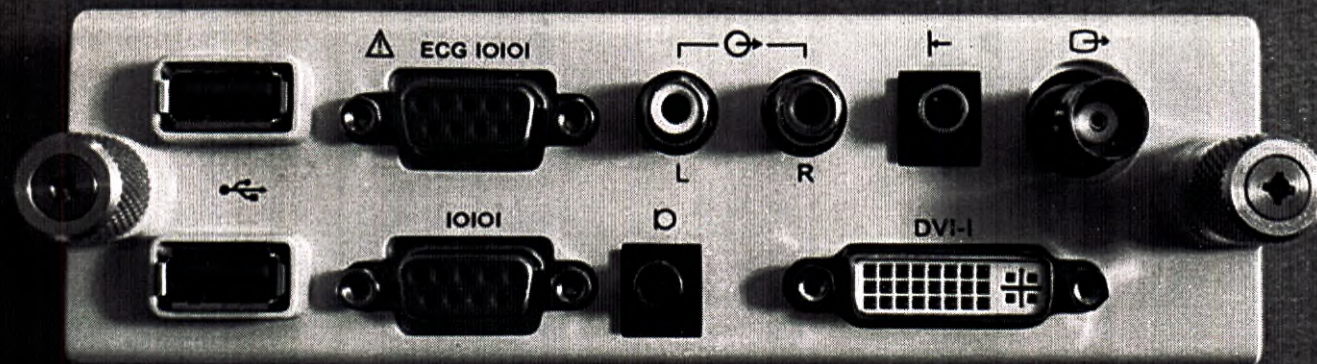





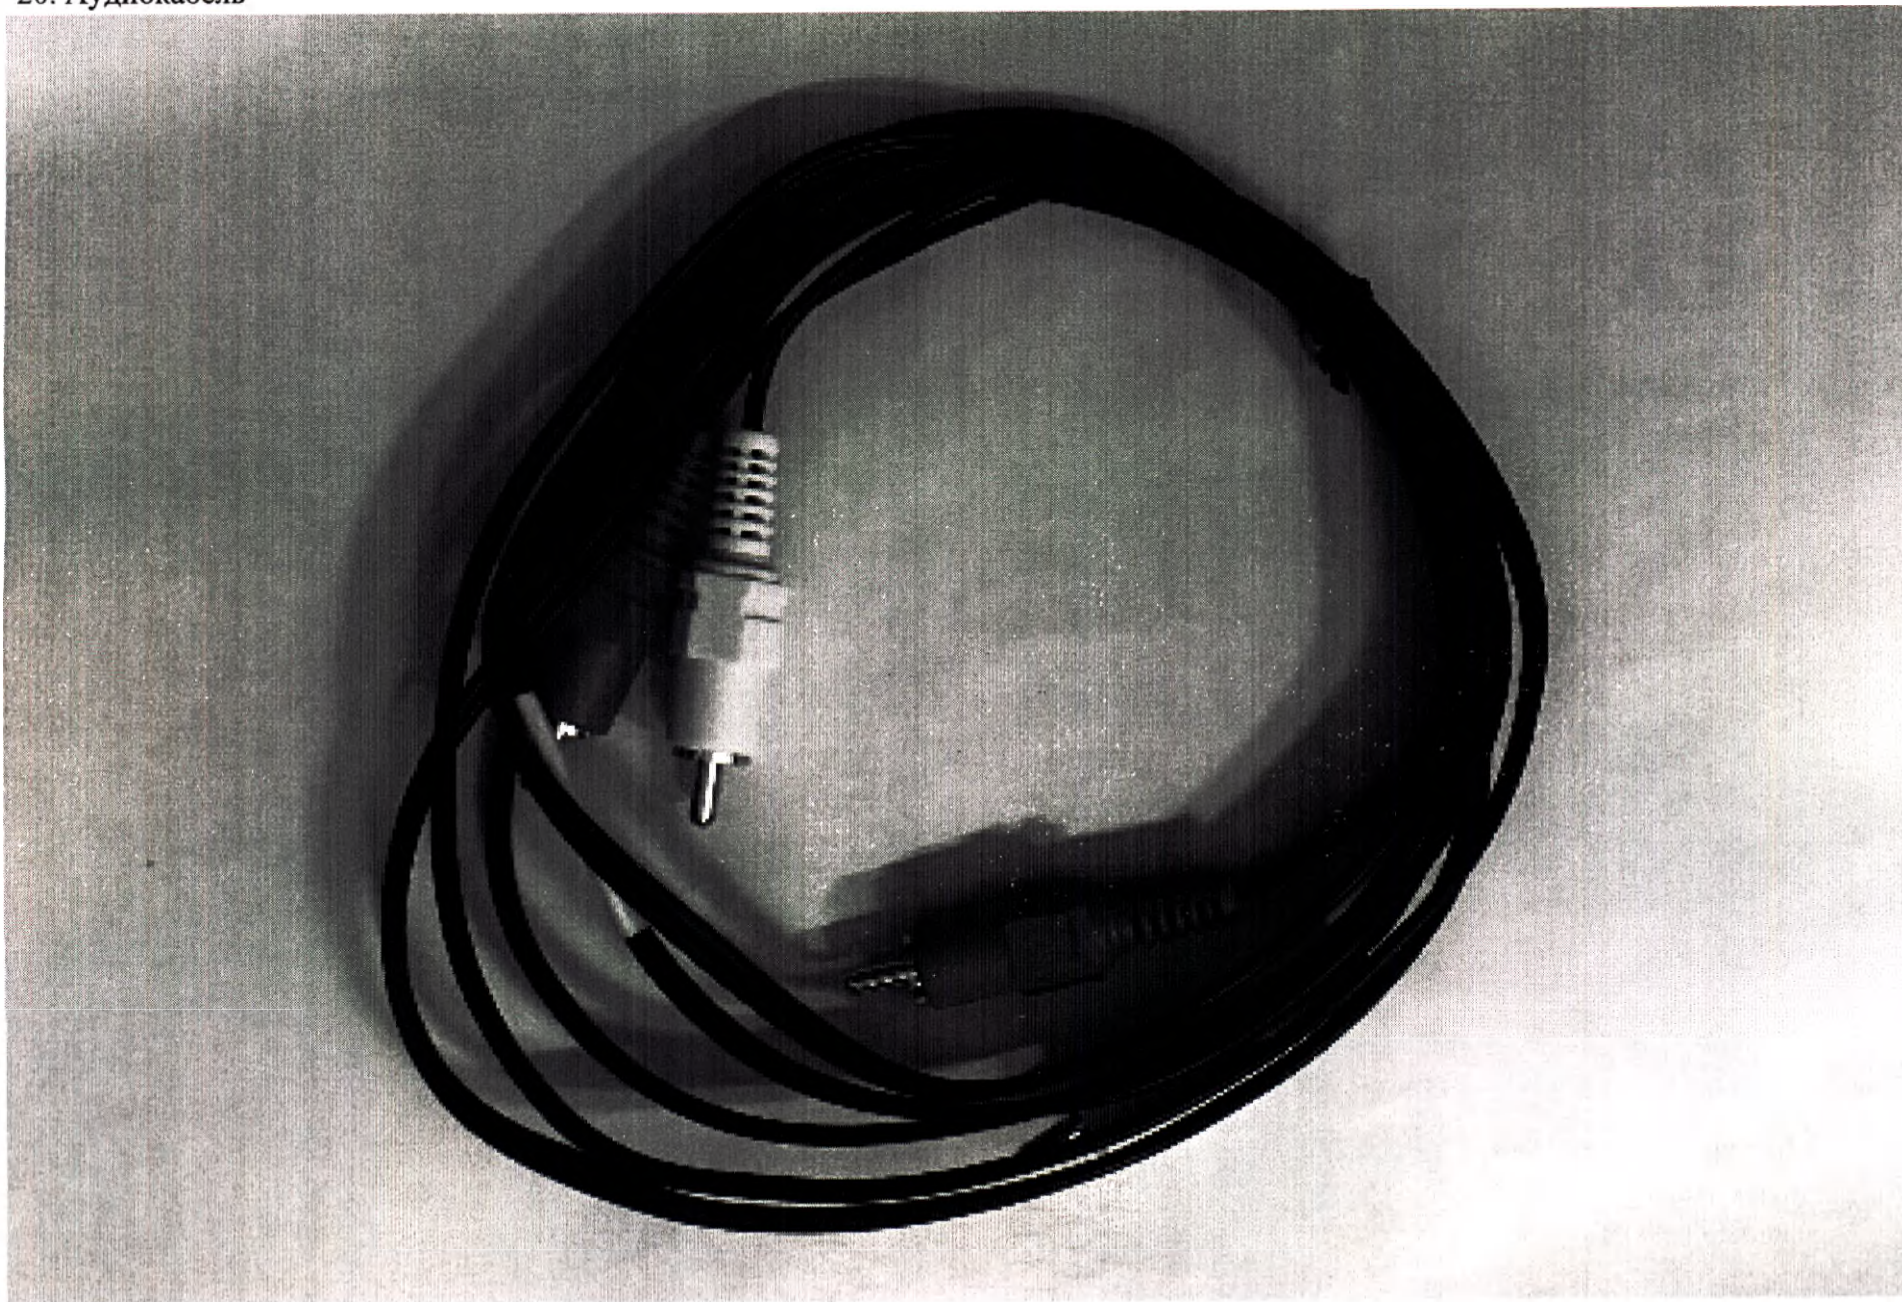







24. Датчики ультразвуковые

24.1. Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s




24.2. Датчик ультразвуковой конвексный ЗС5s





24.3. Датчик ультразвуковой конвексный объемный 4CD4s



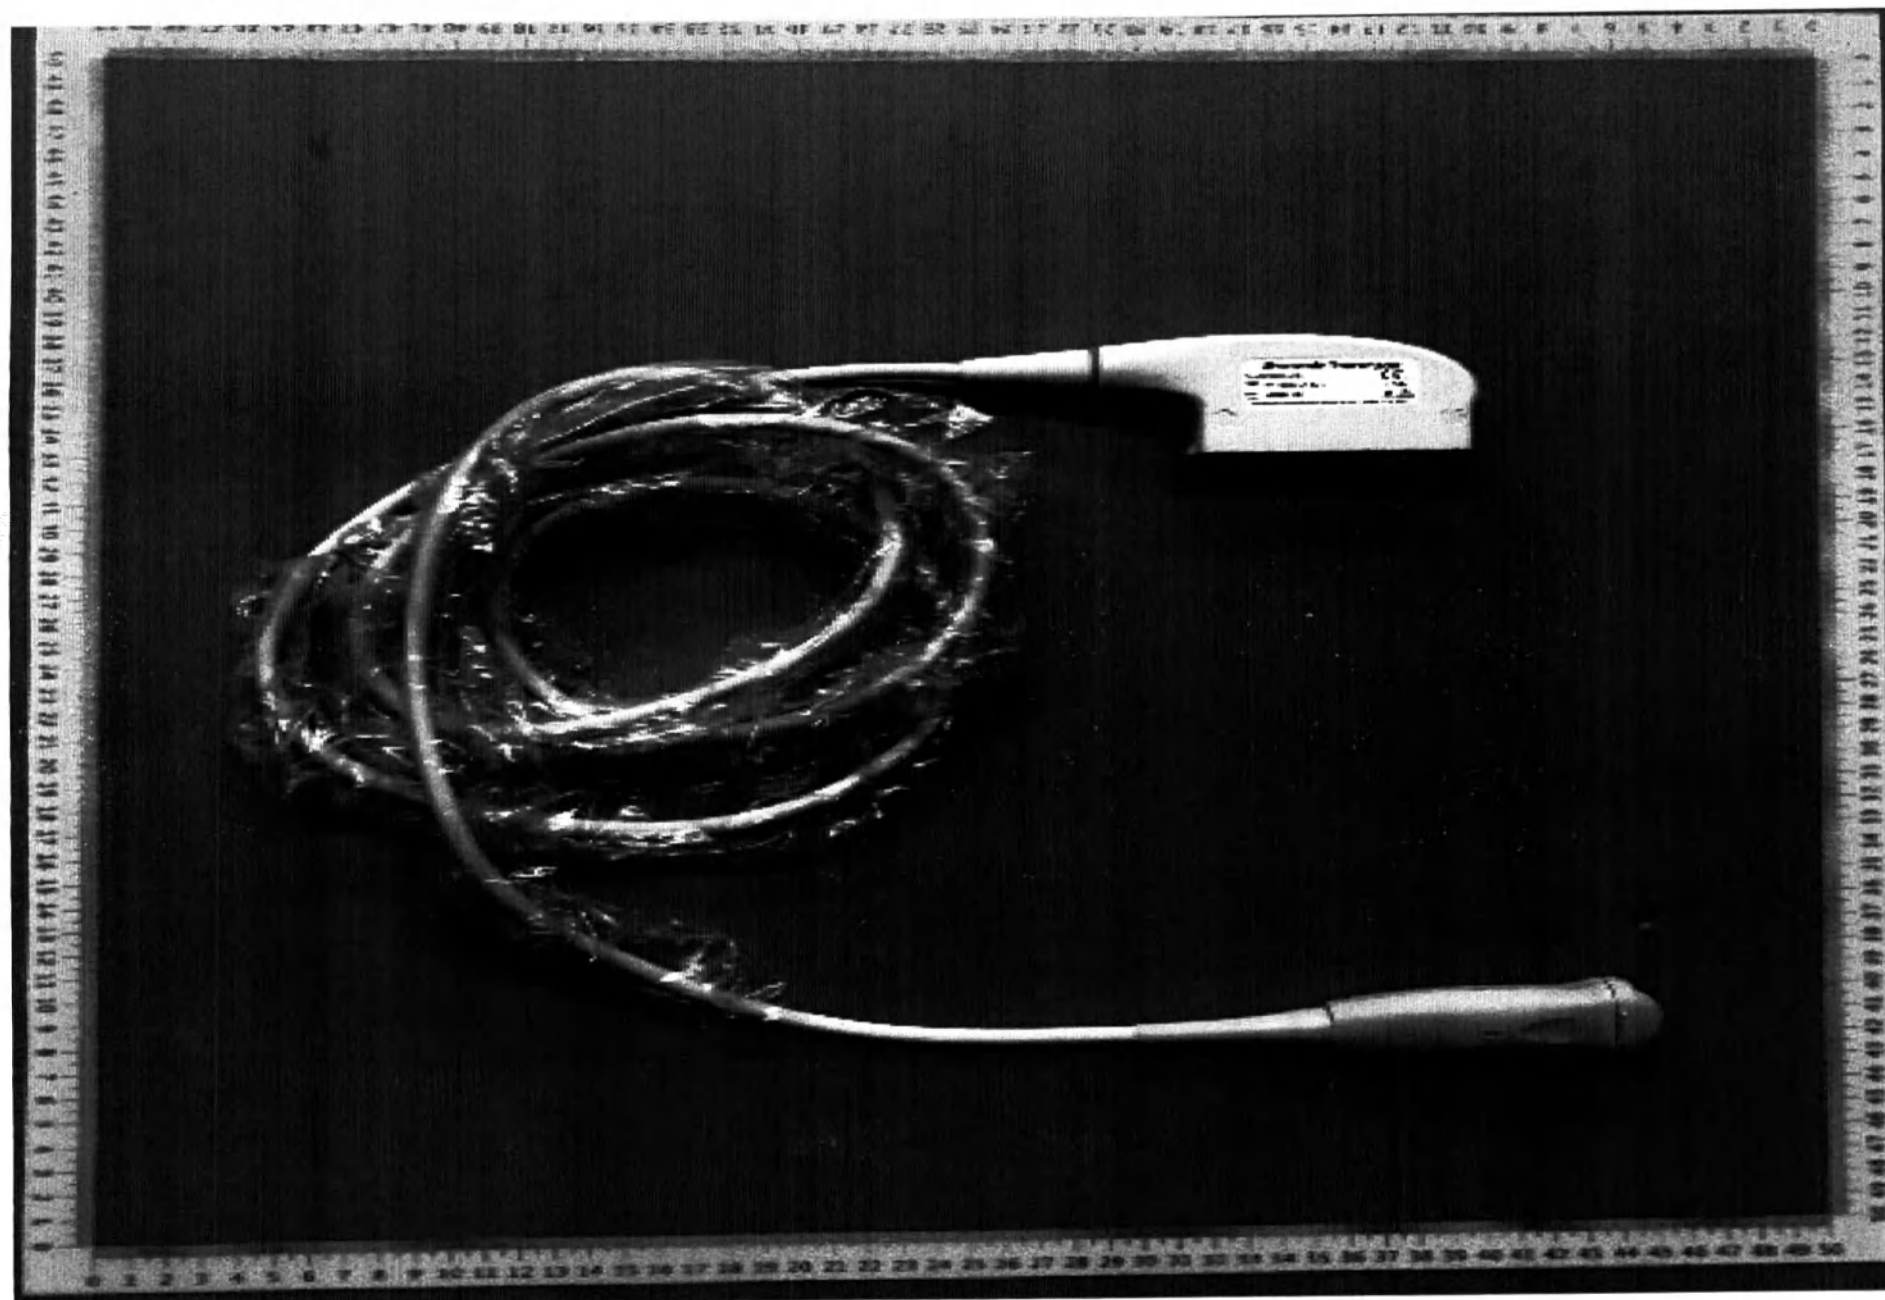


24.5. Датчик ультразвуковой конвексный внутривидеостной 6CV1s

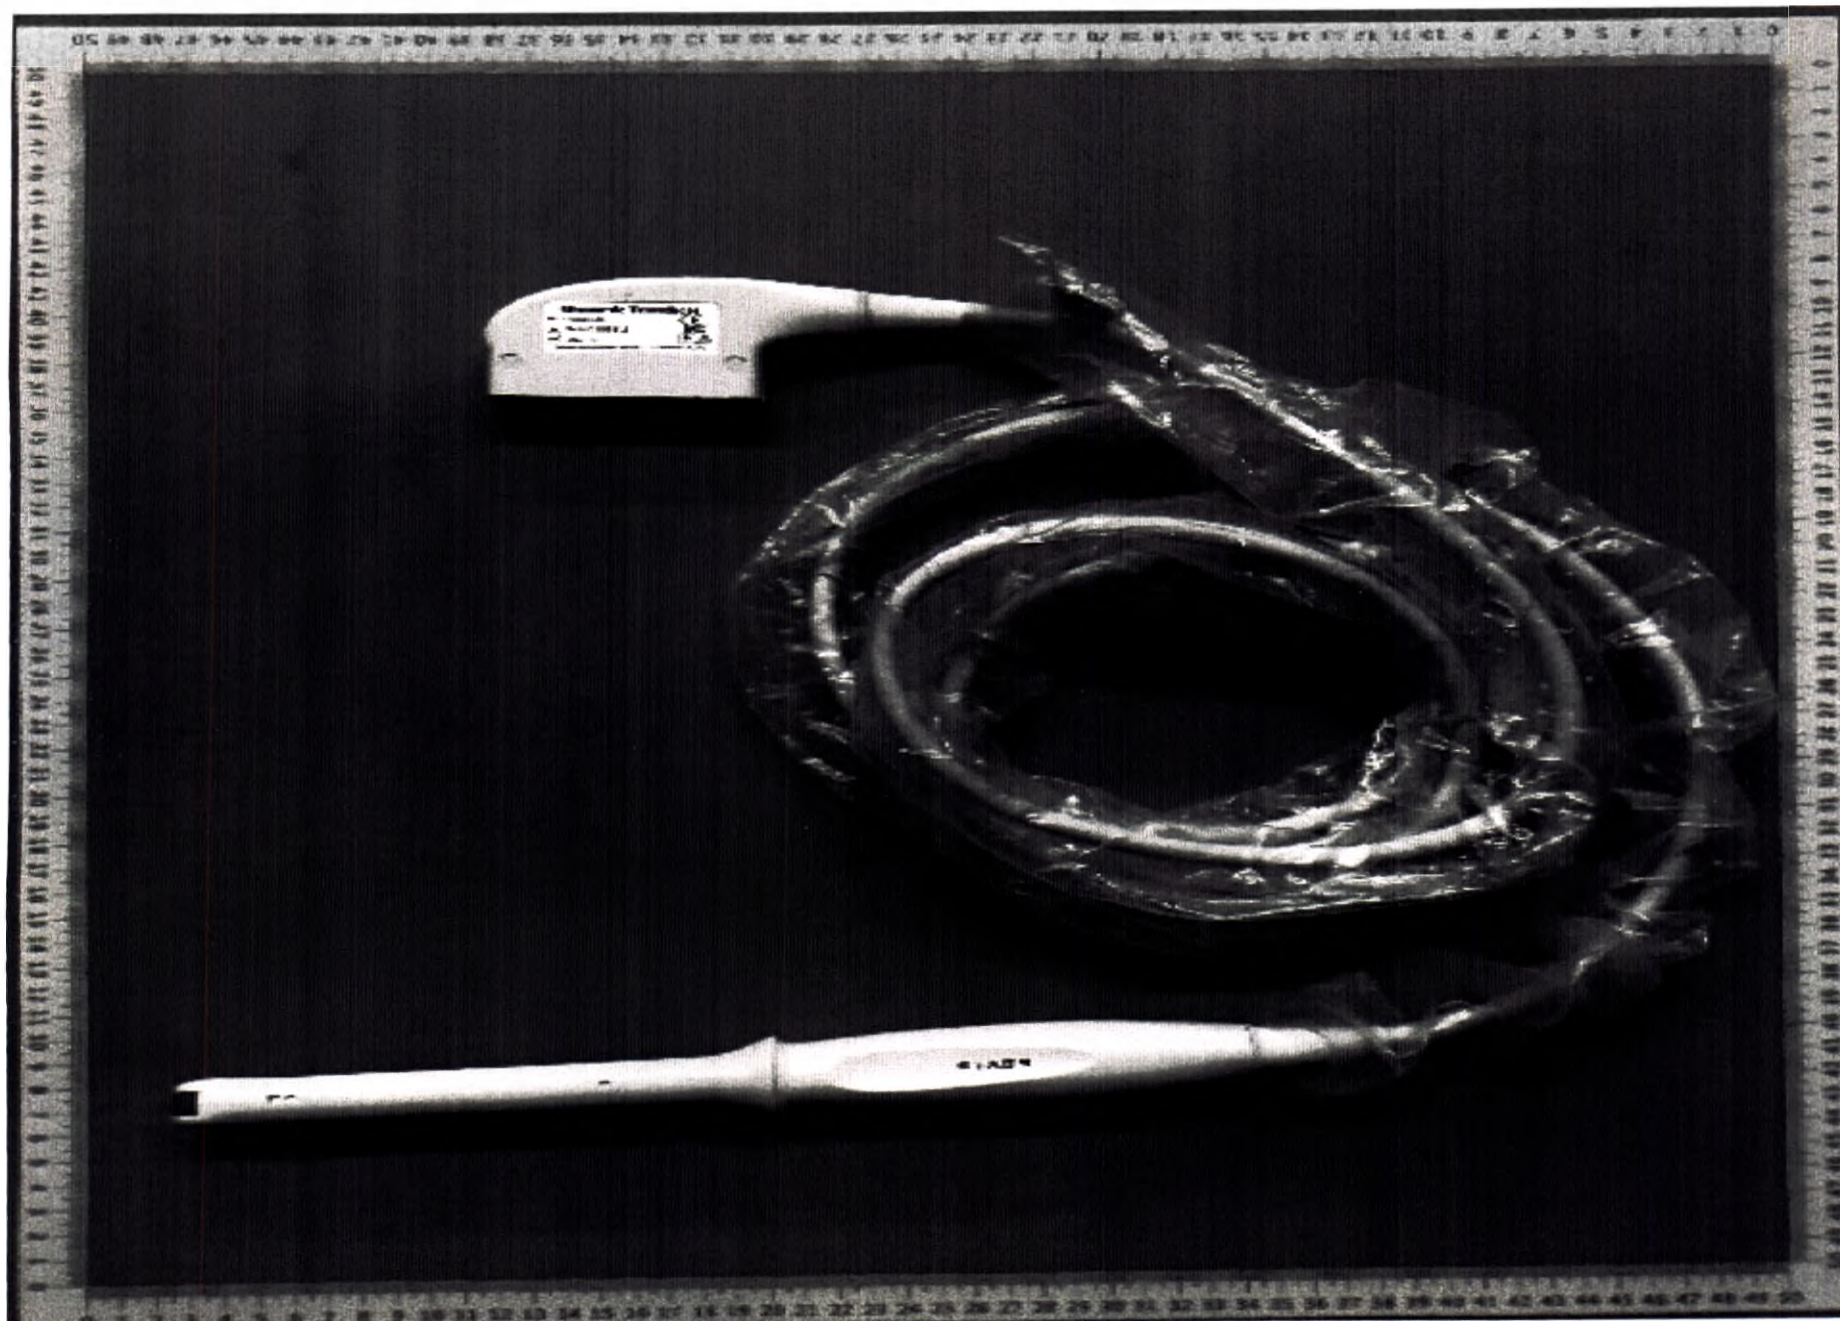

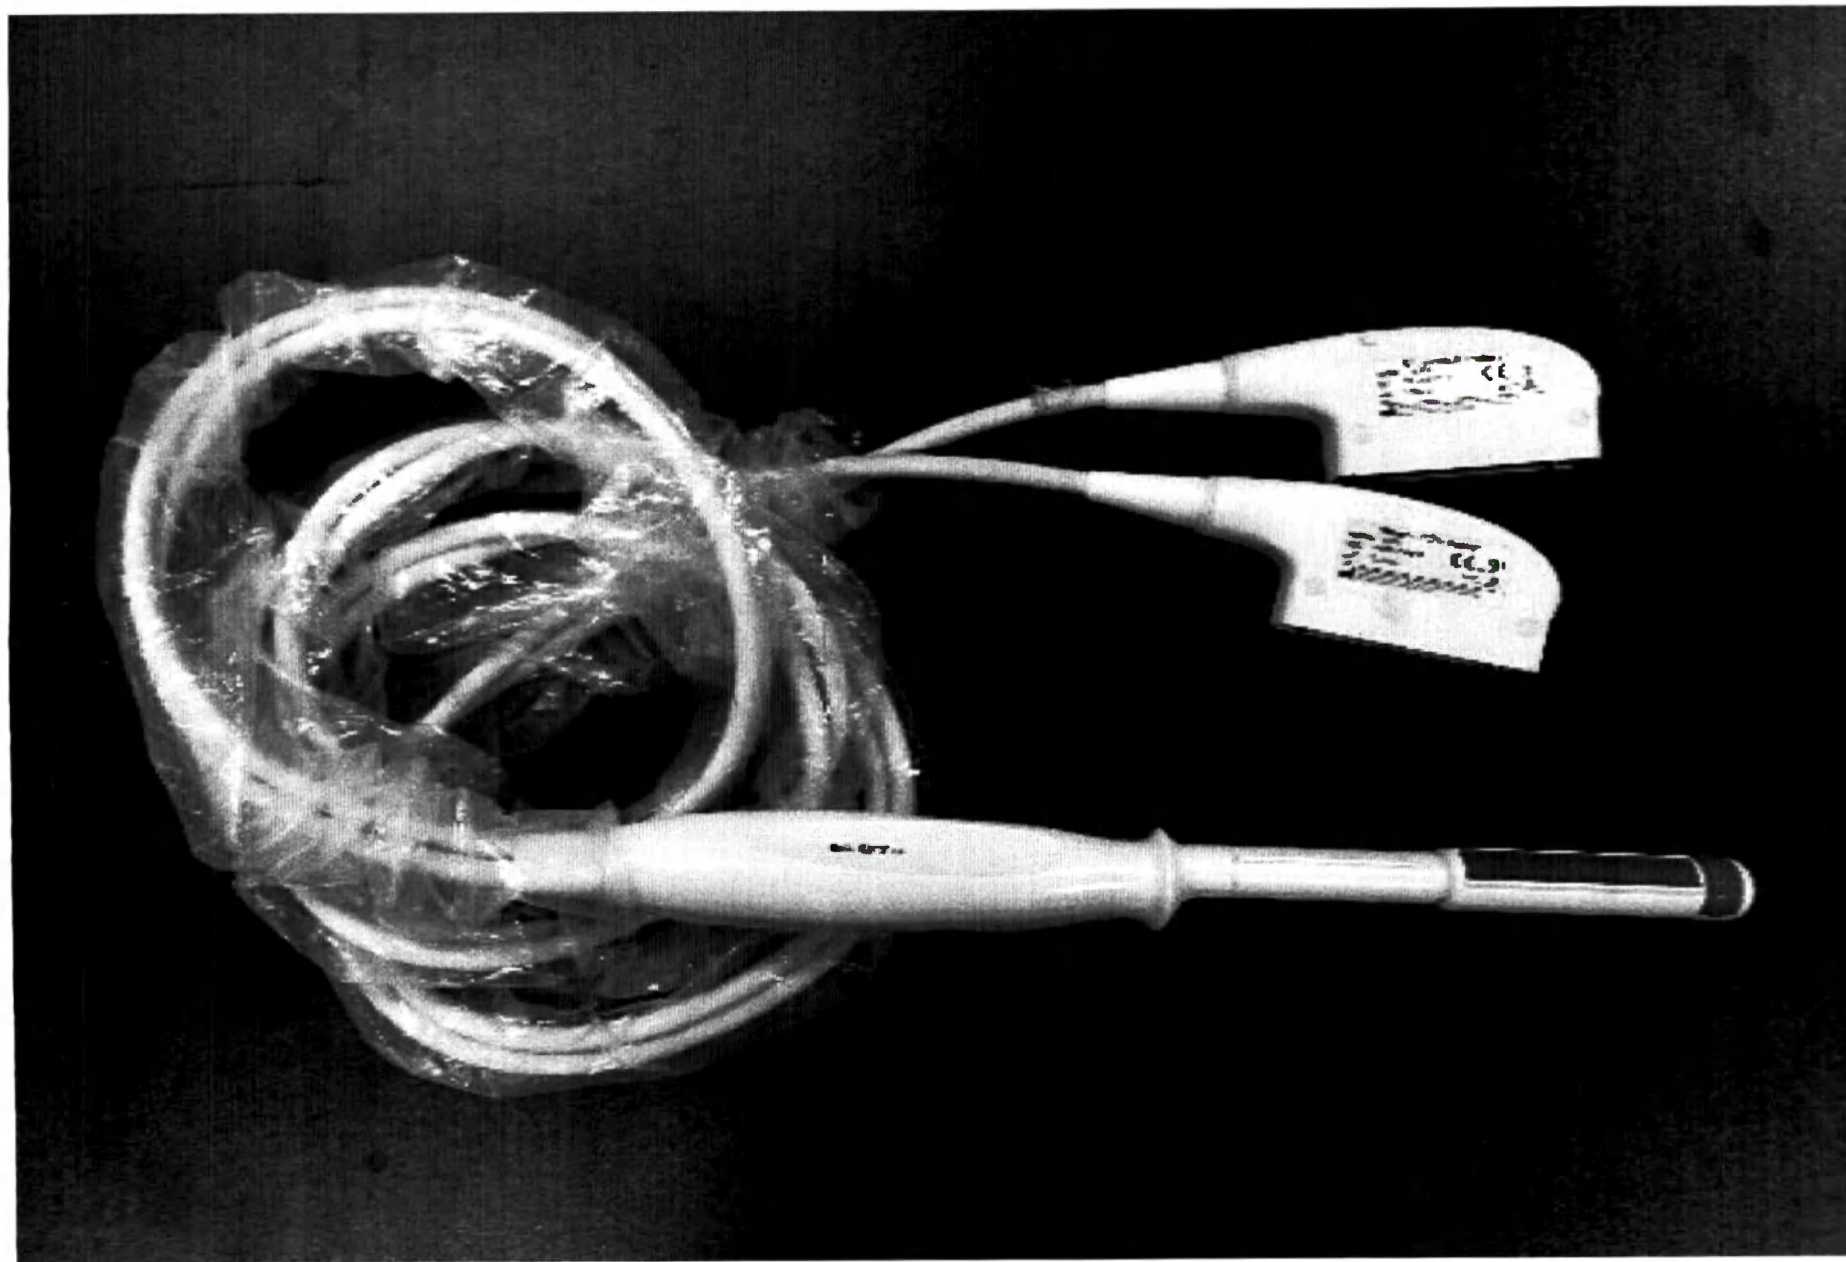

24.7. Датчик ультразвуковой линейный 7L4s

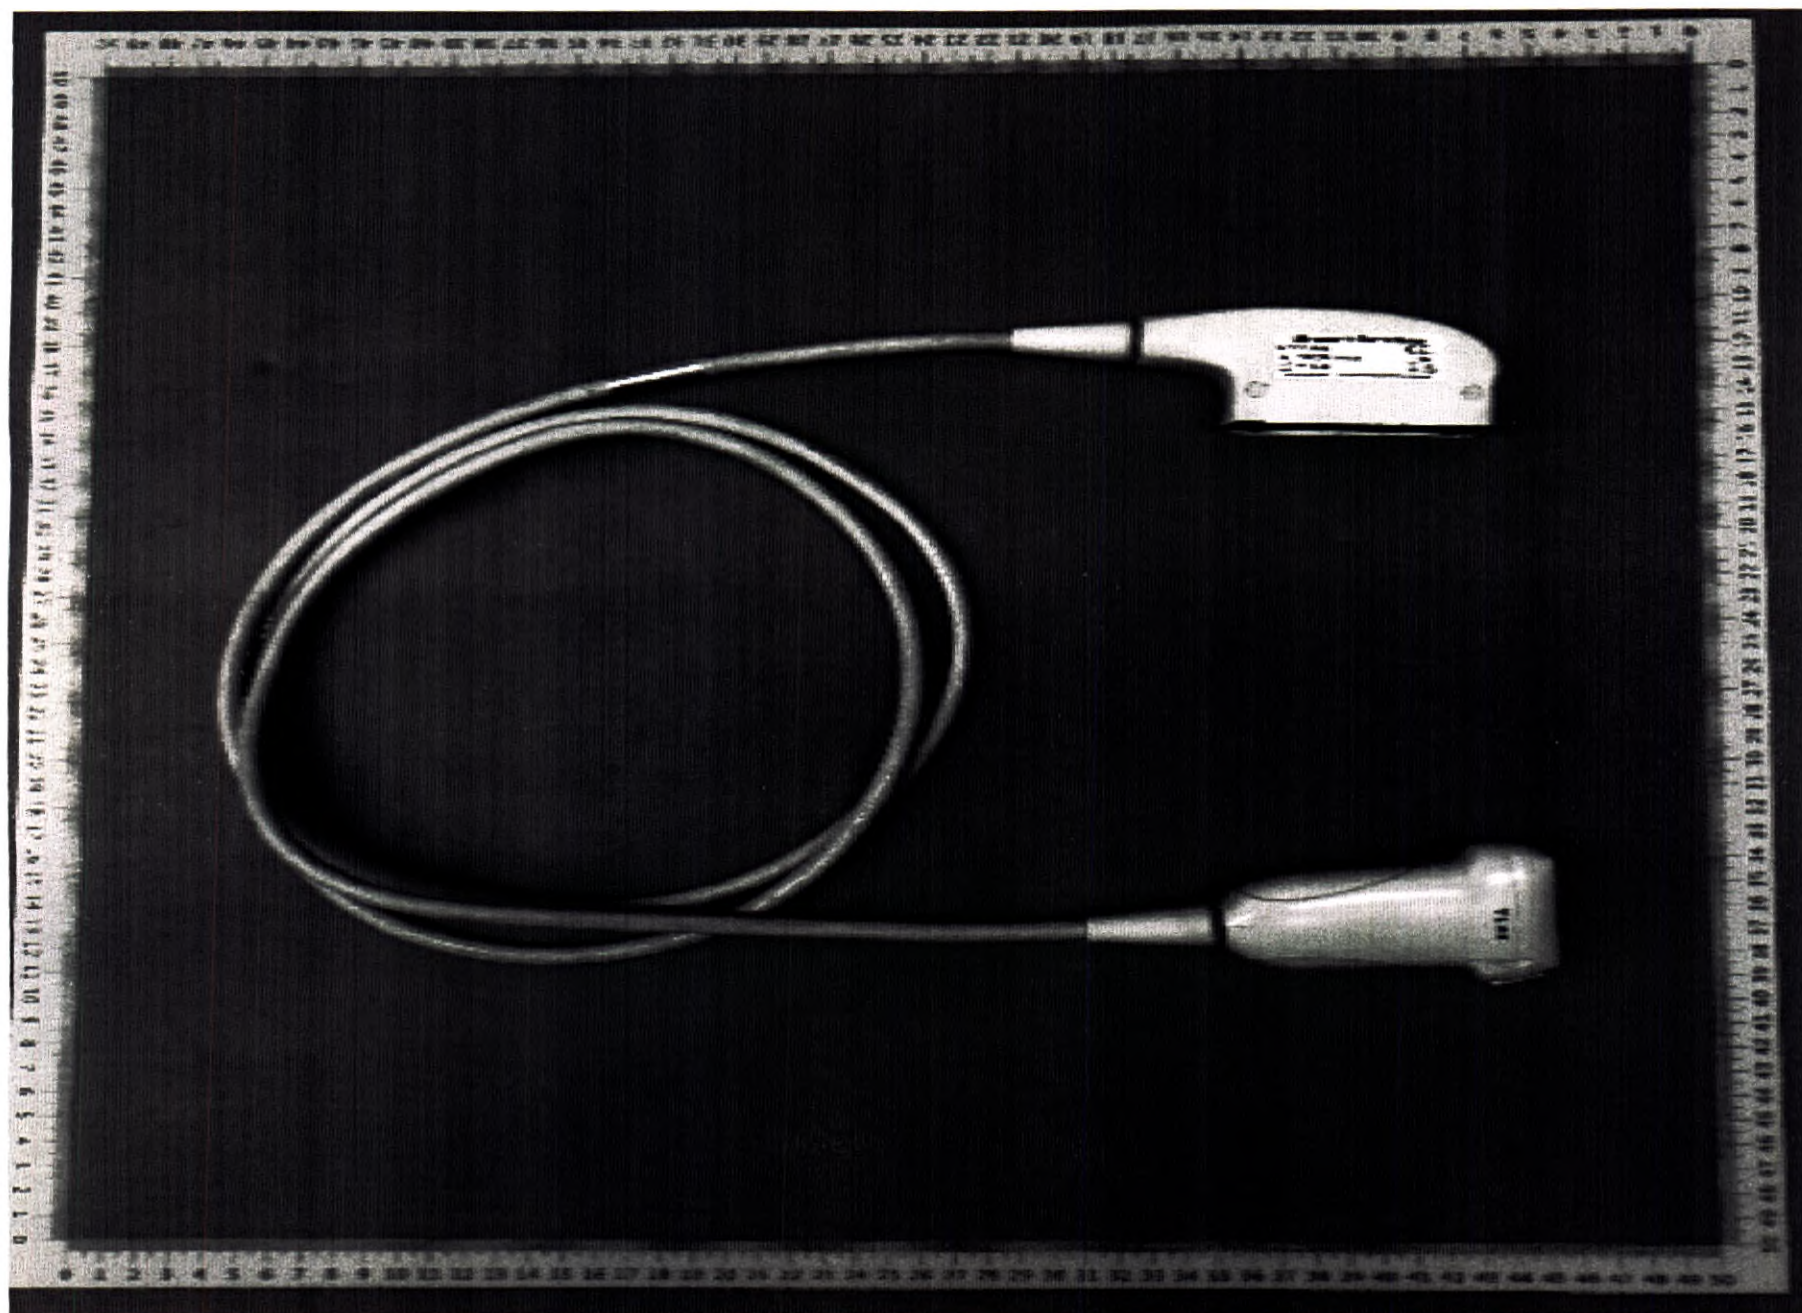




24.9. Датчик ультразвуковой линейный 7LT4s









24.12. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2s

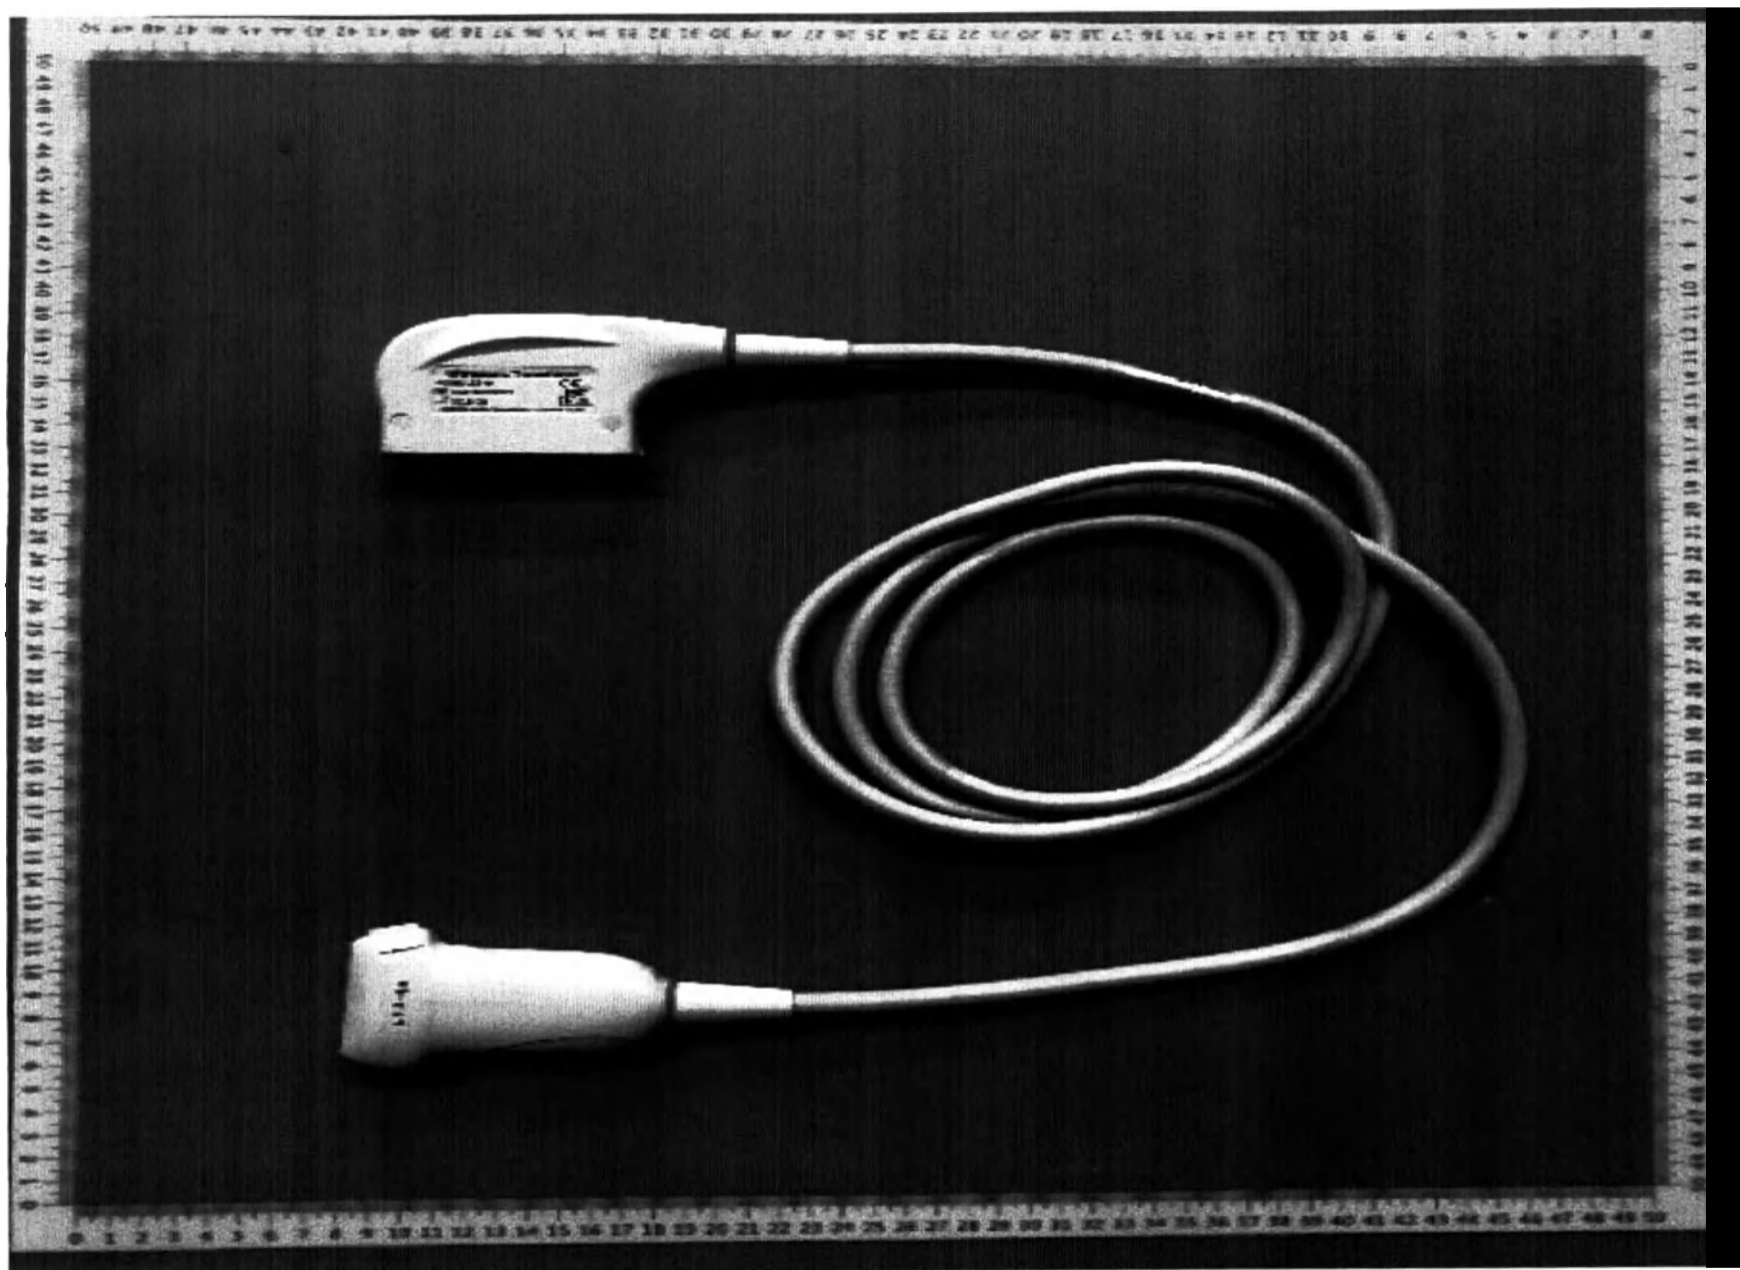


24.13. Датчик ультразвуковой линейный L12-4s

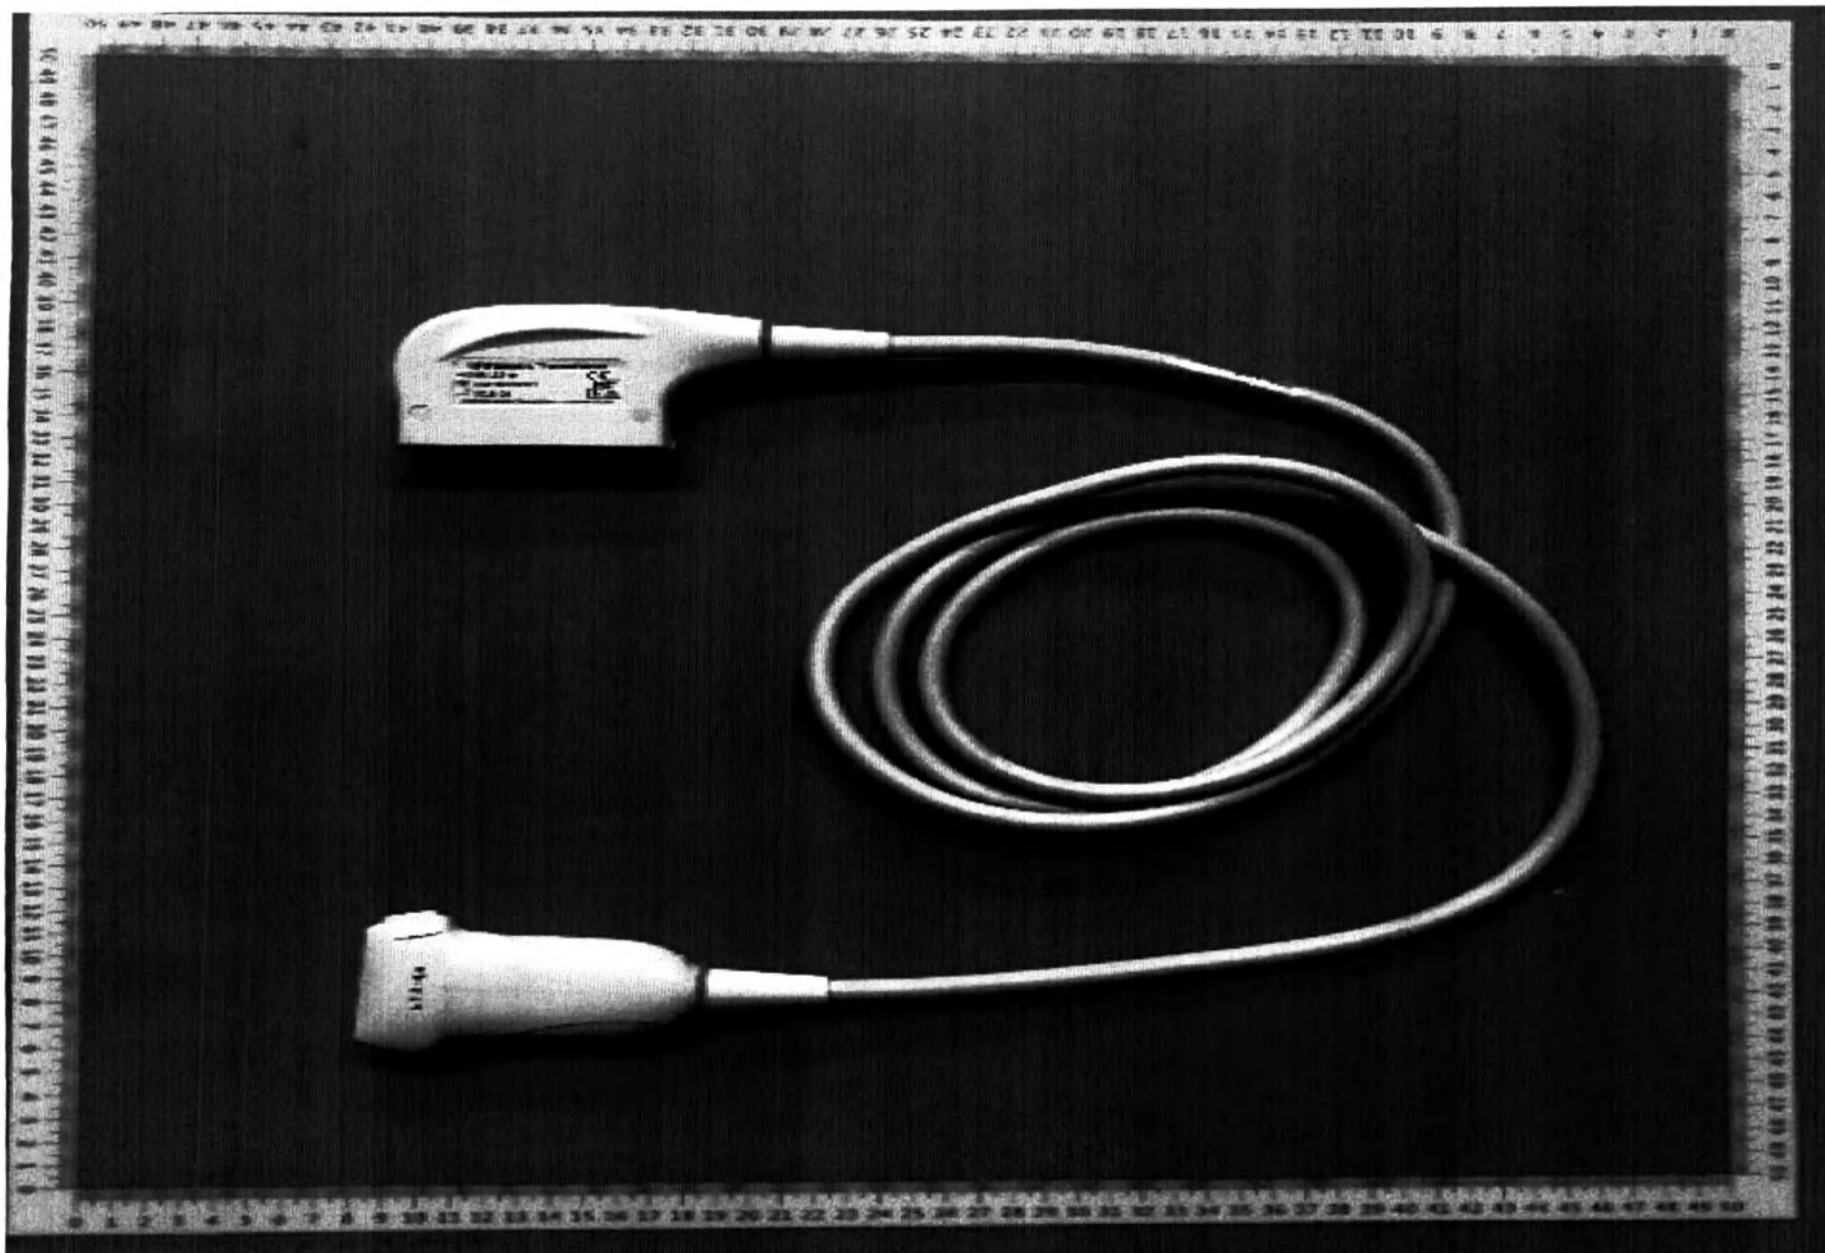



24.14. Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

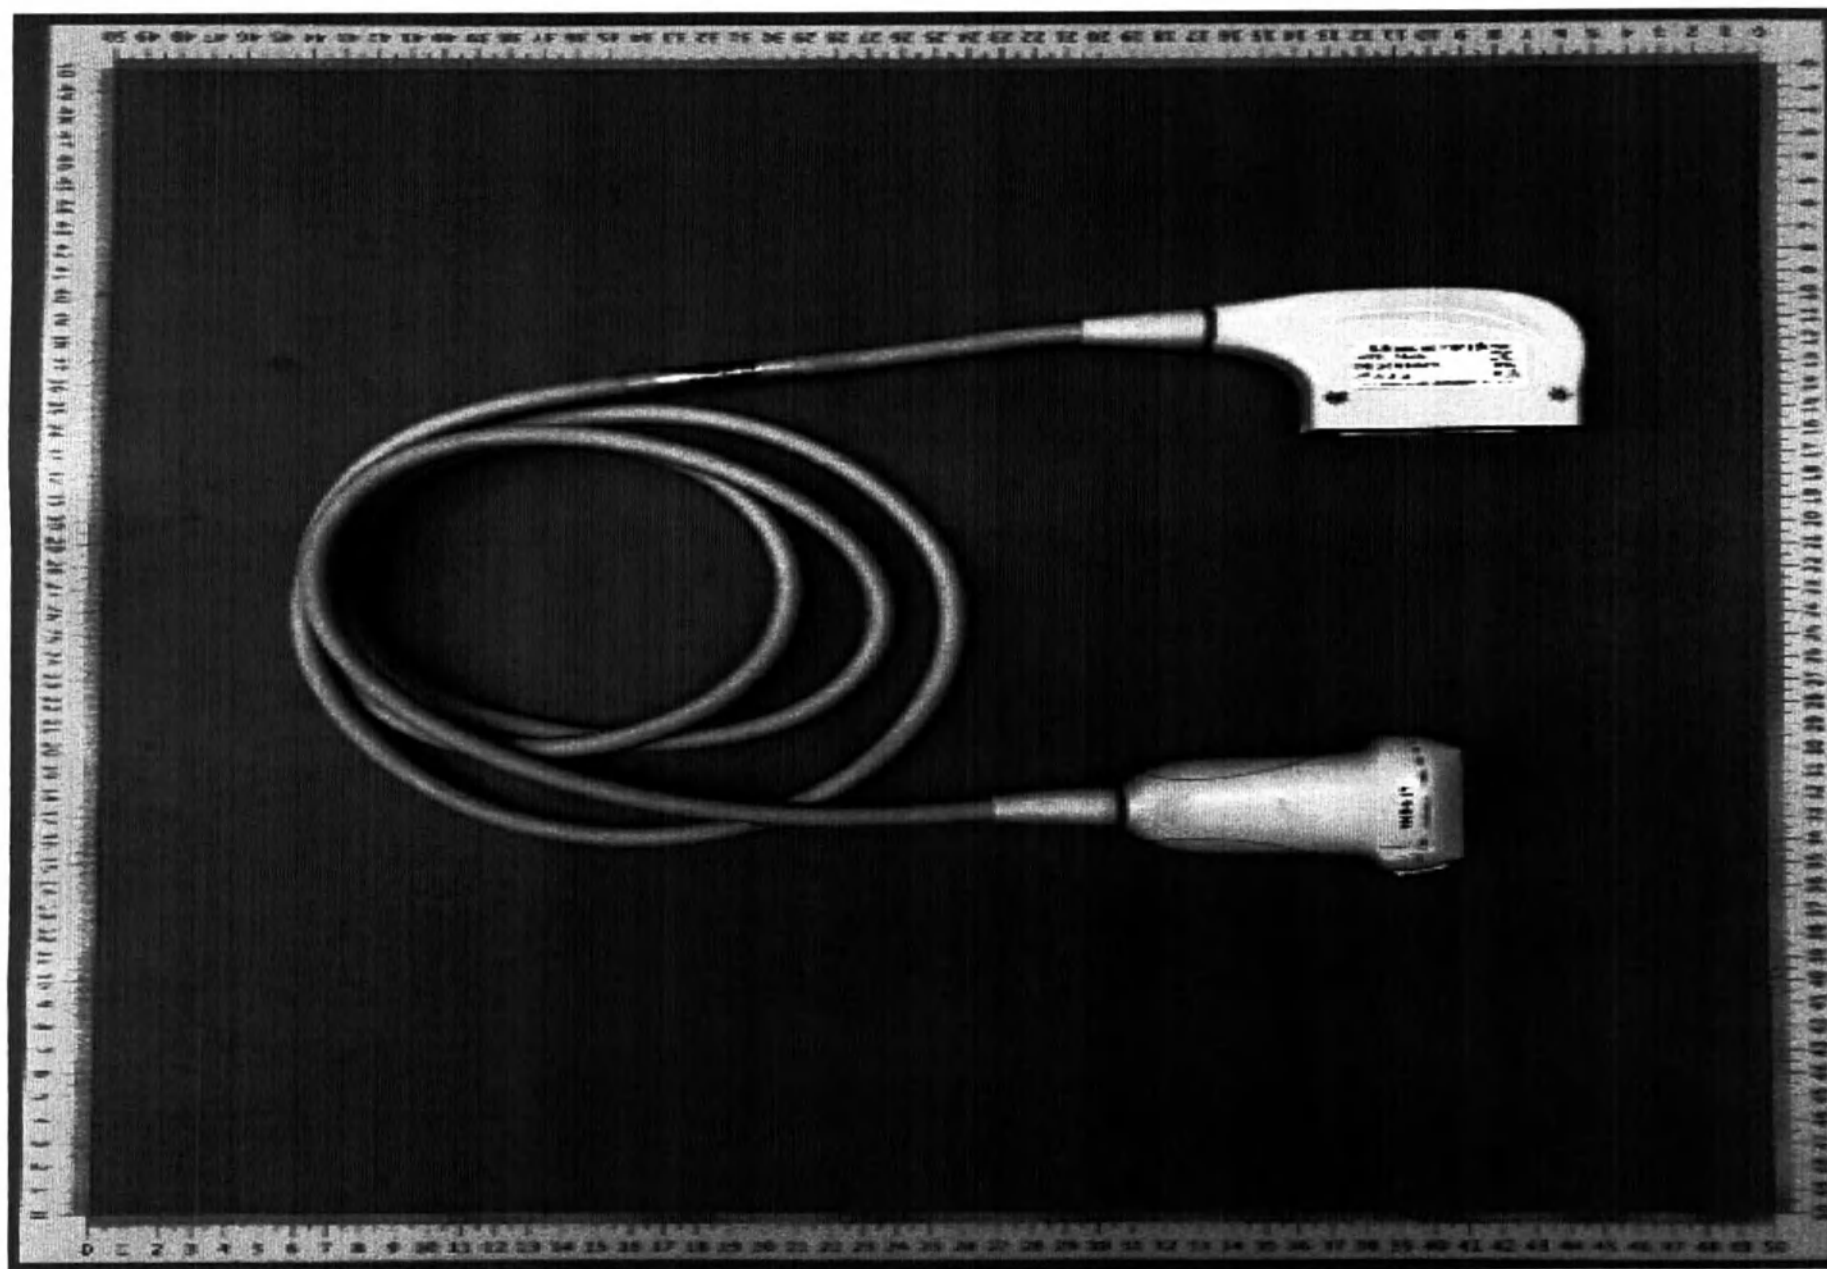




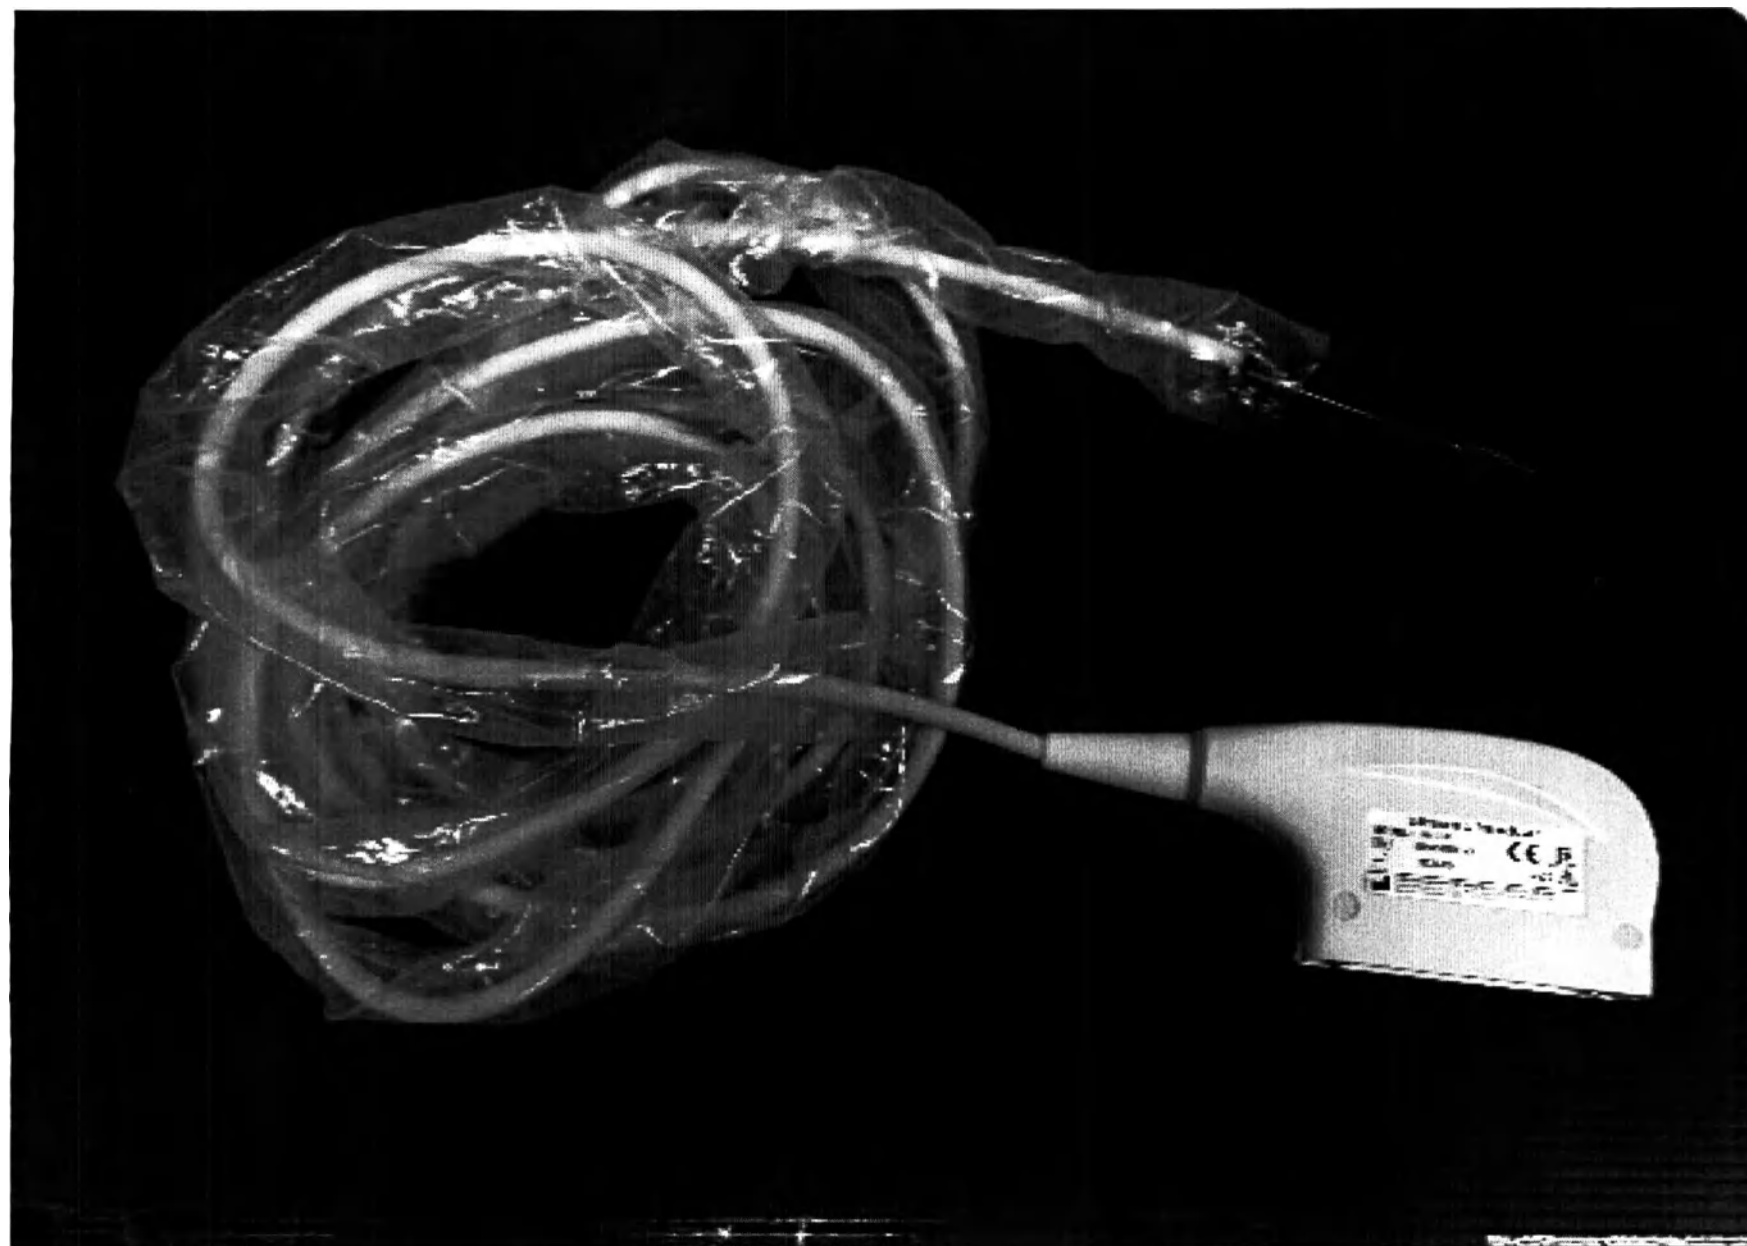

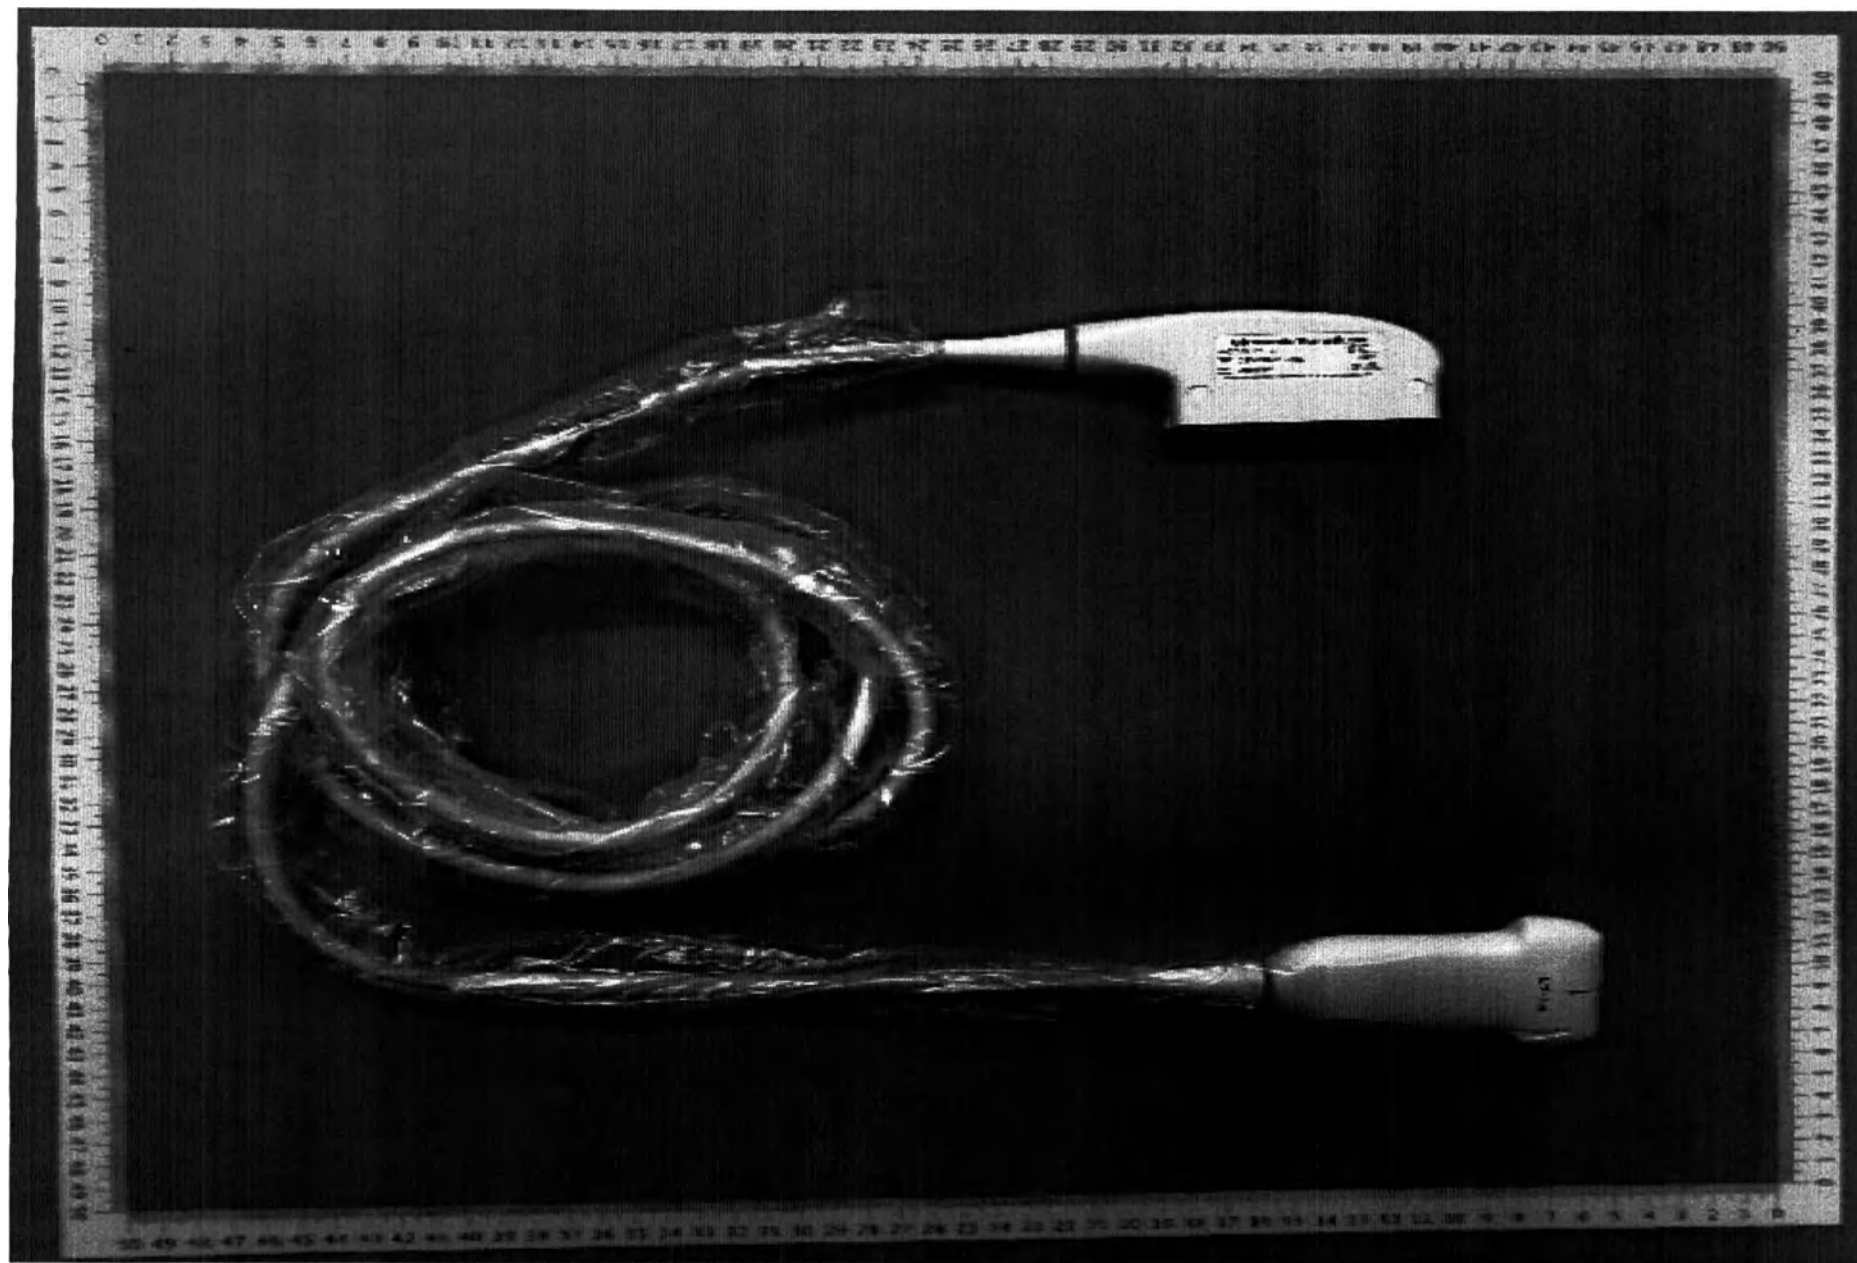

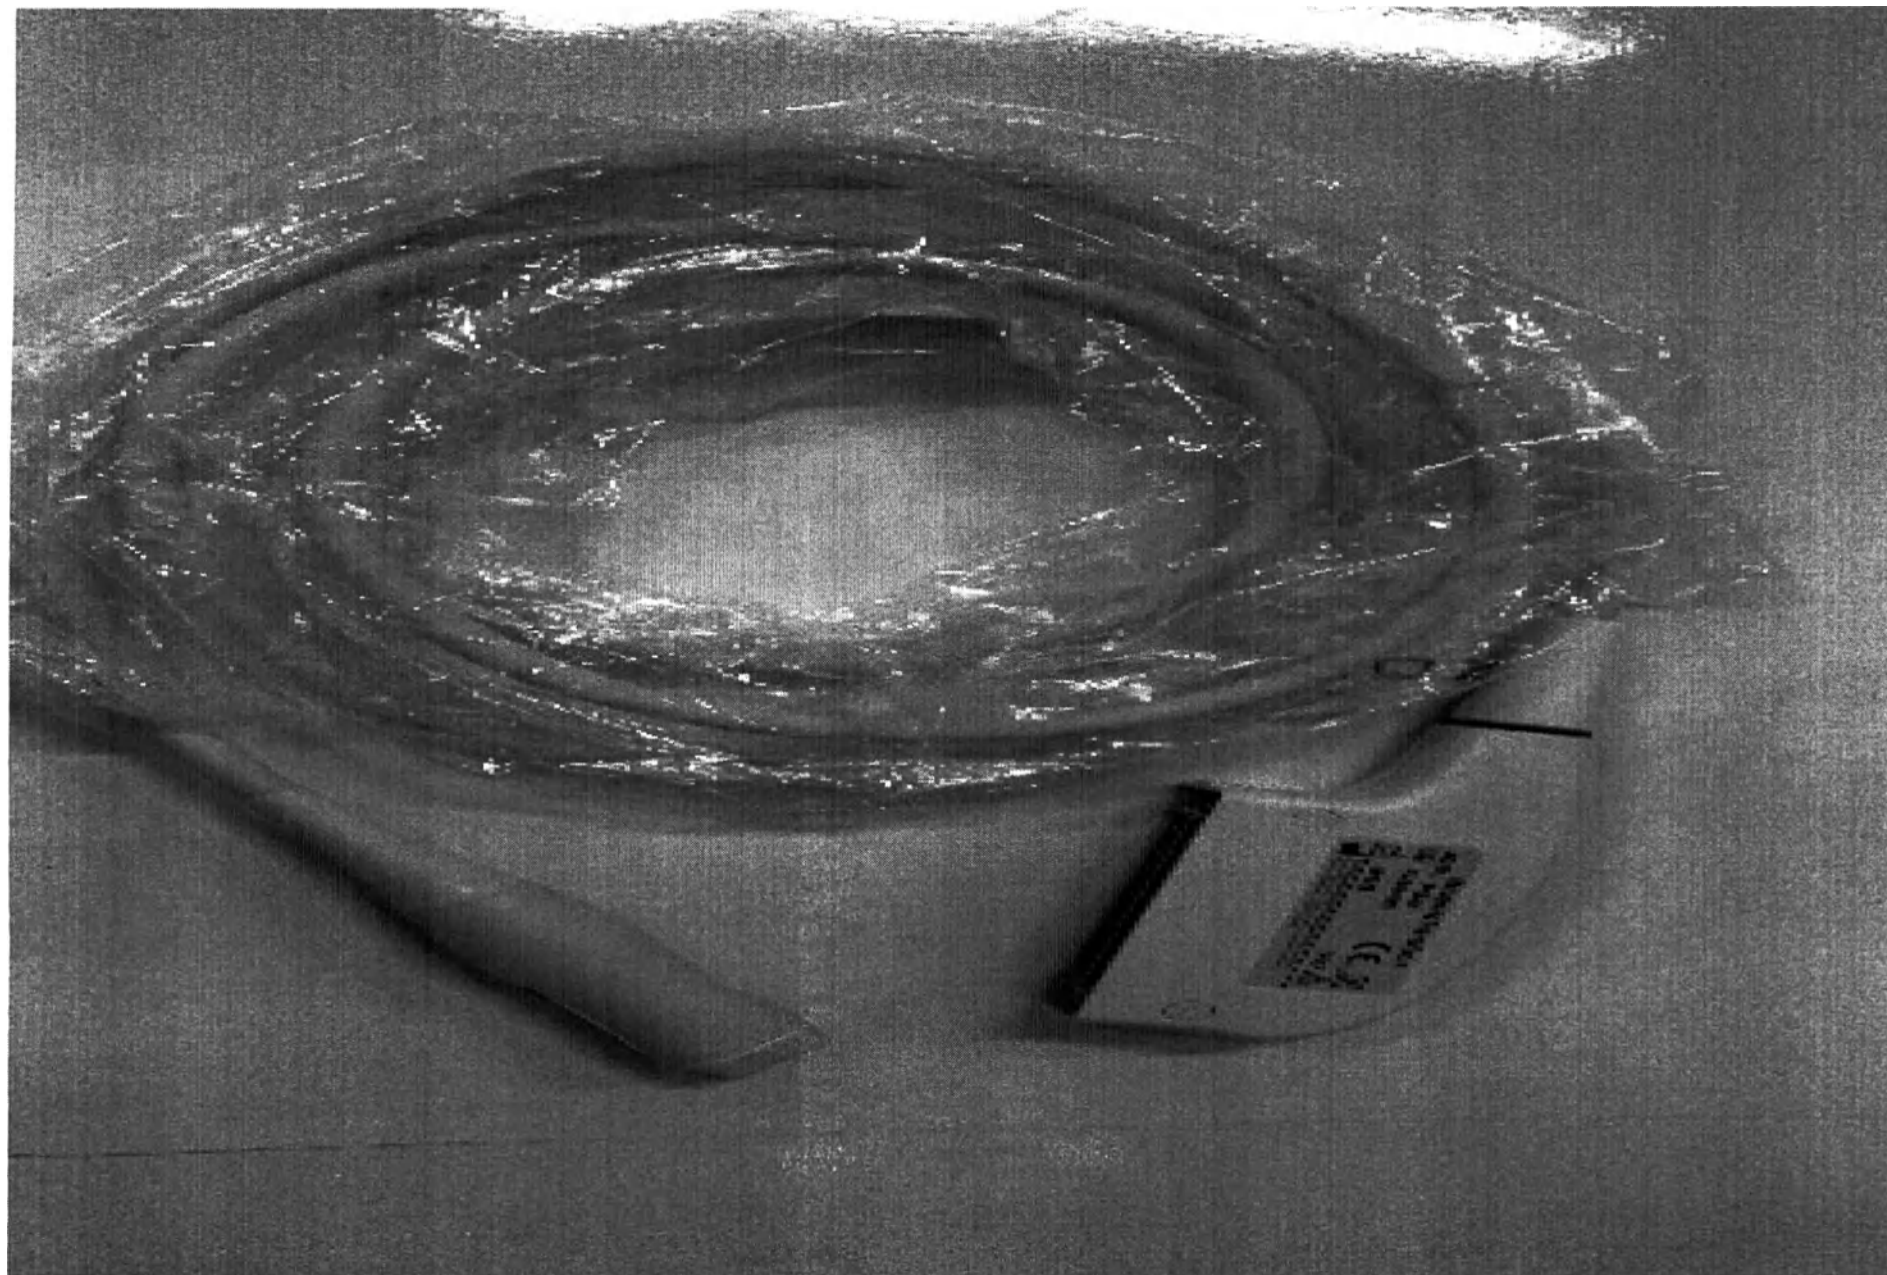




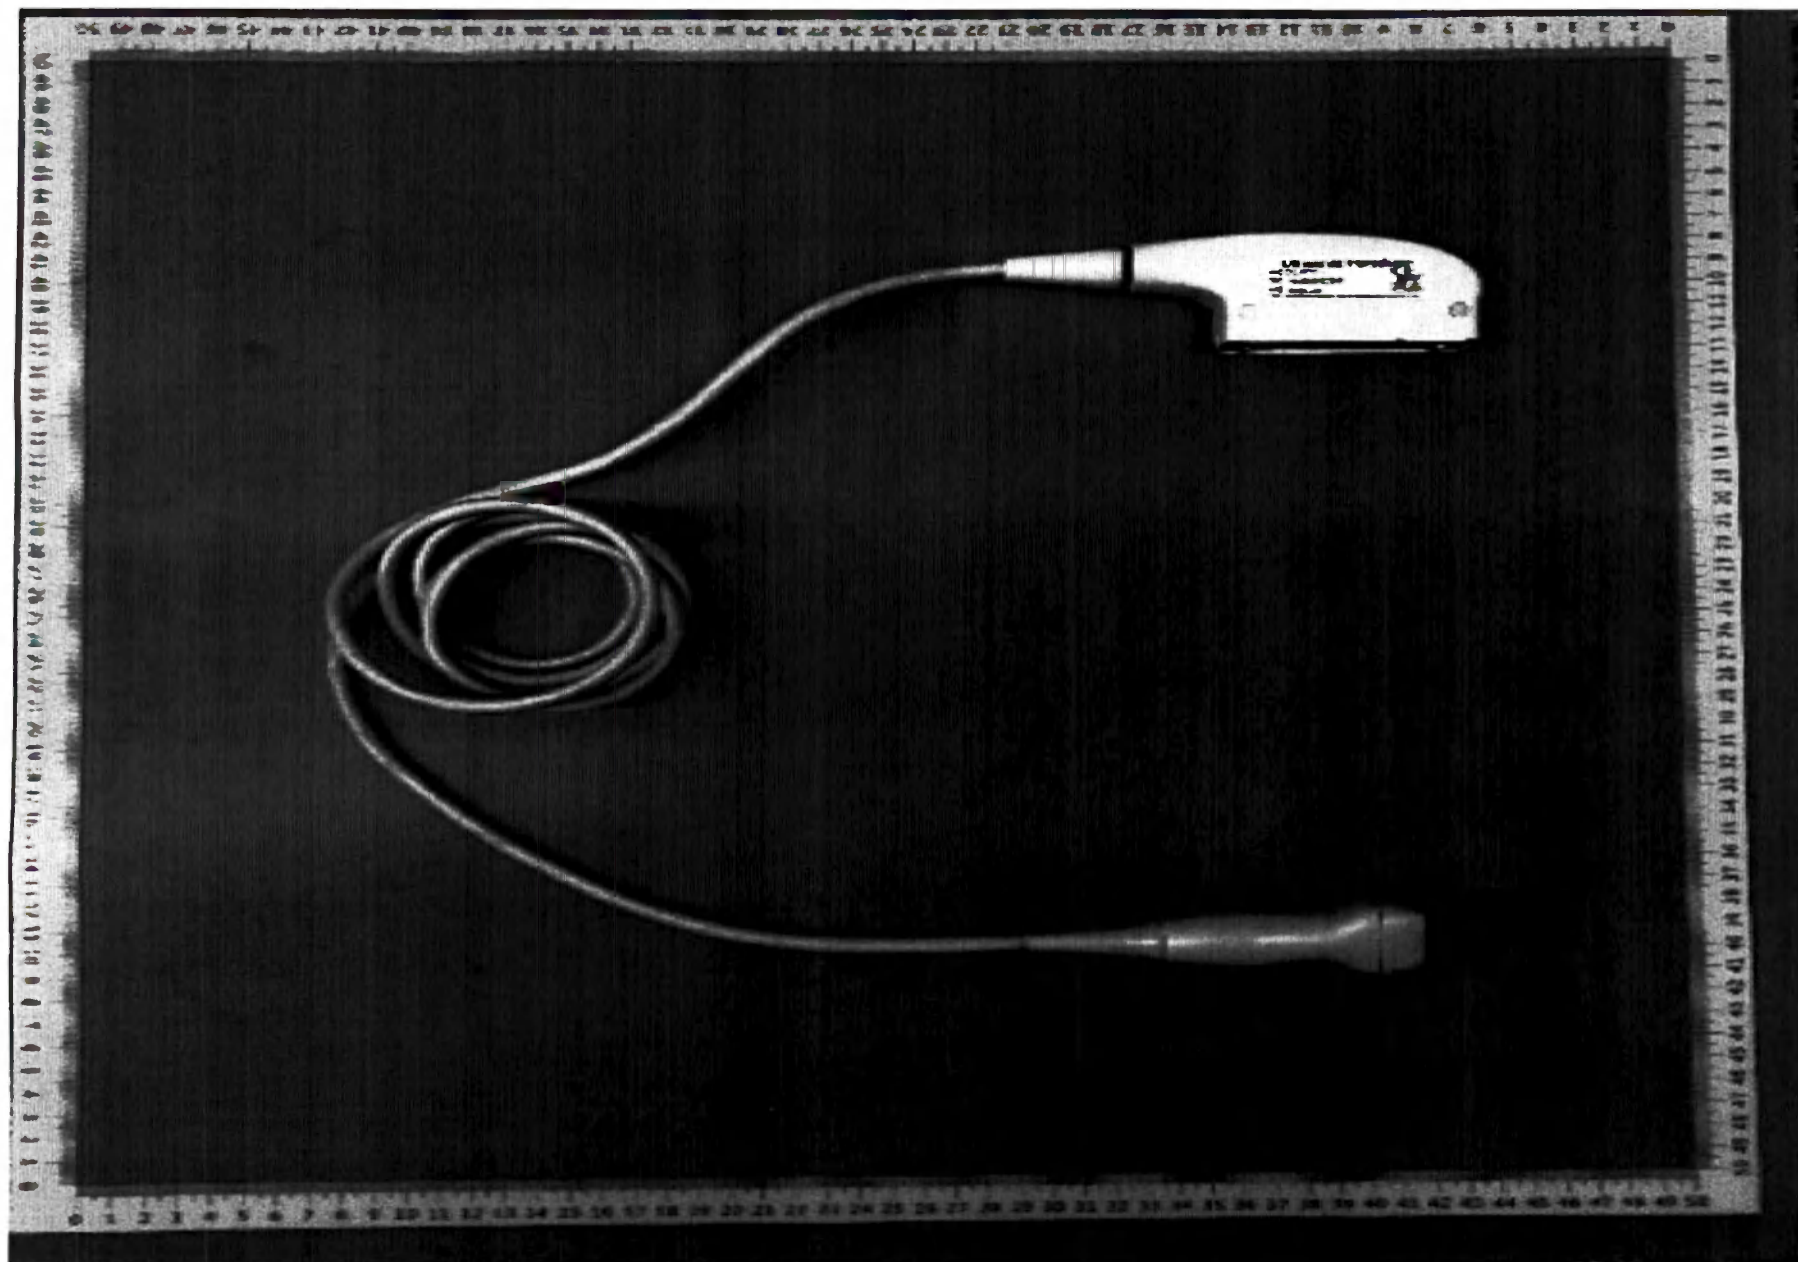



24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный Р7-3Ts в составе:

24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

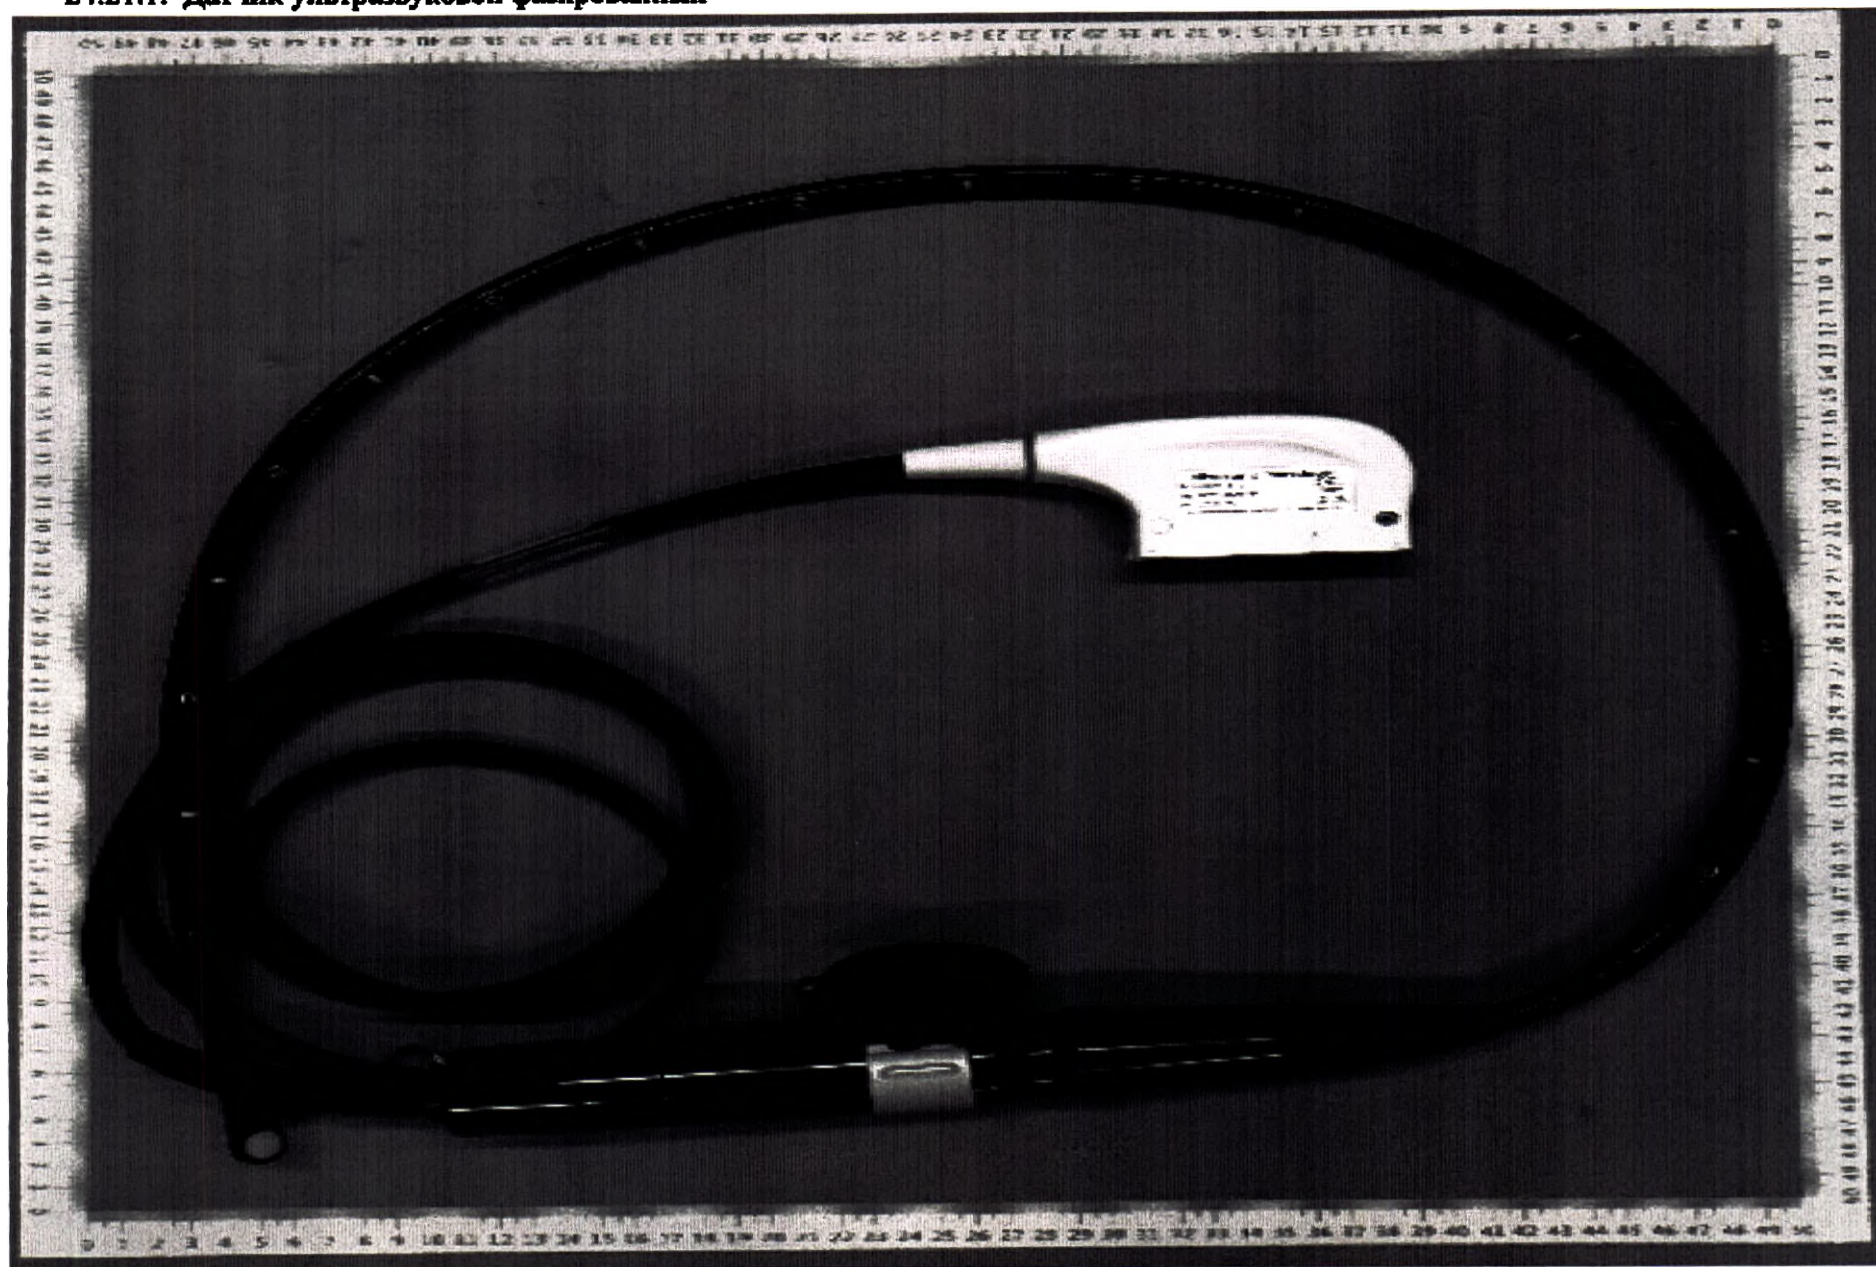




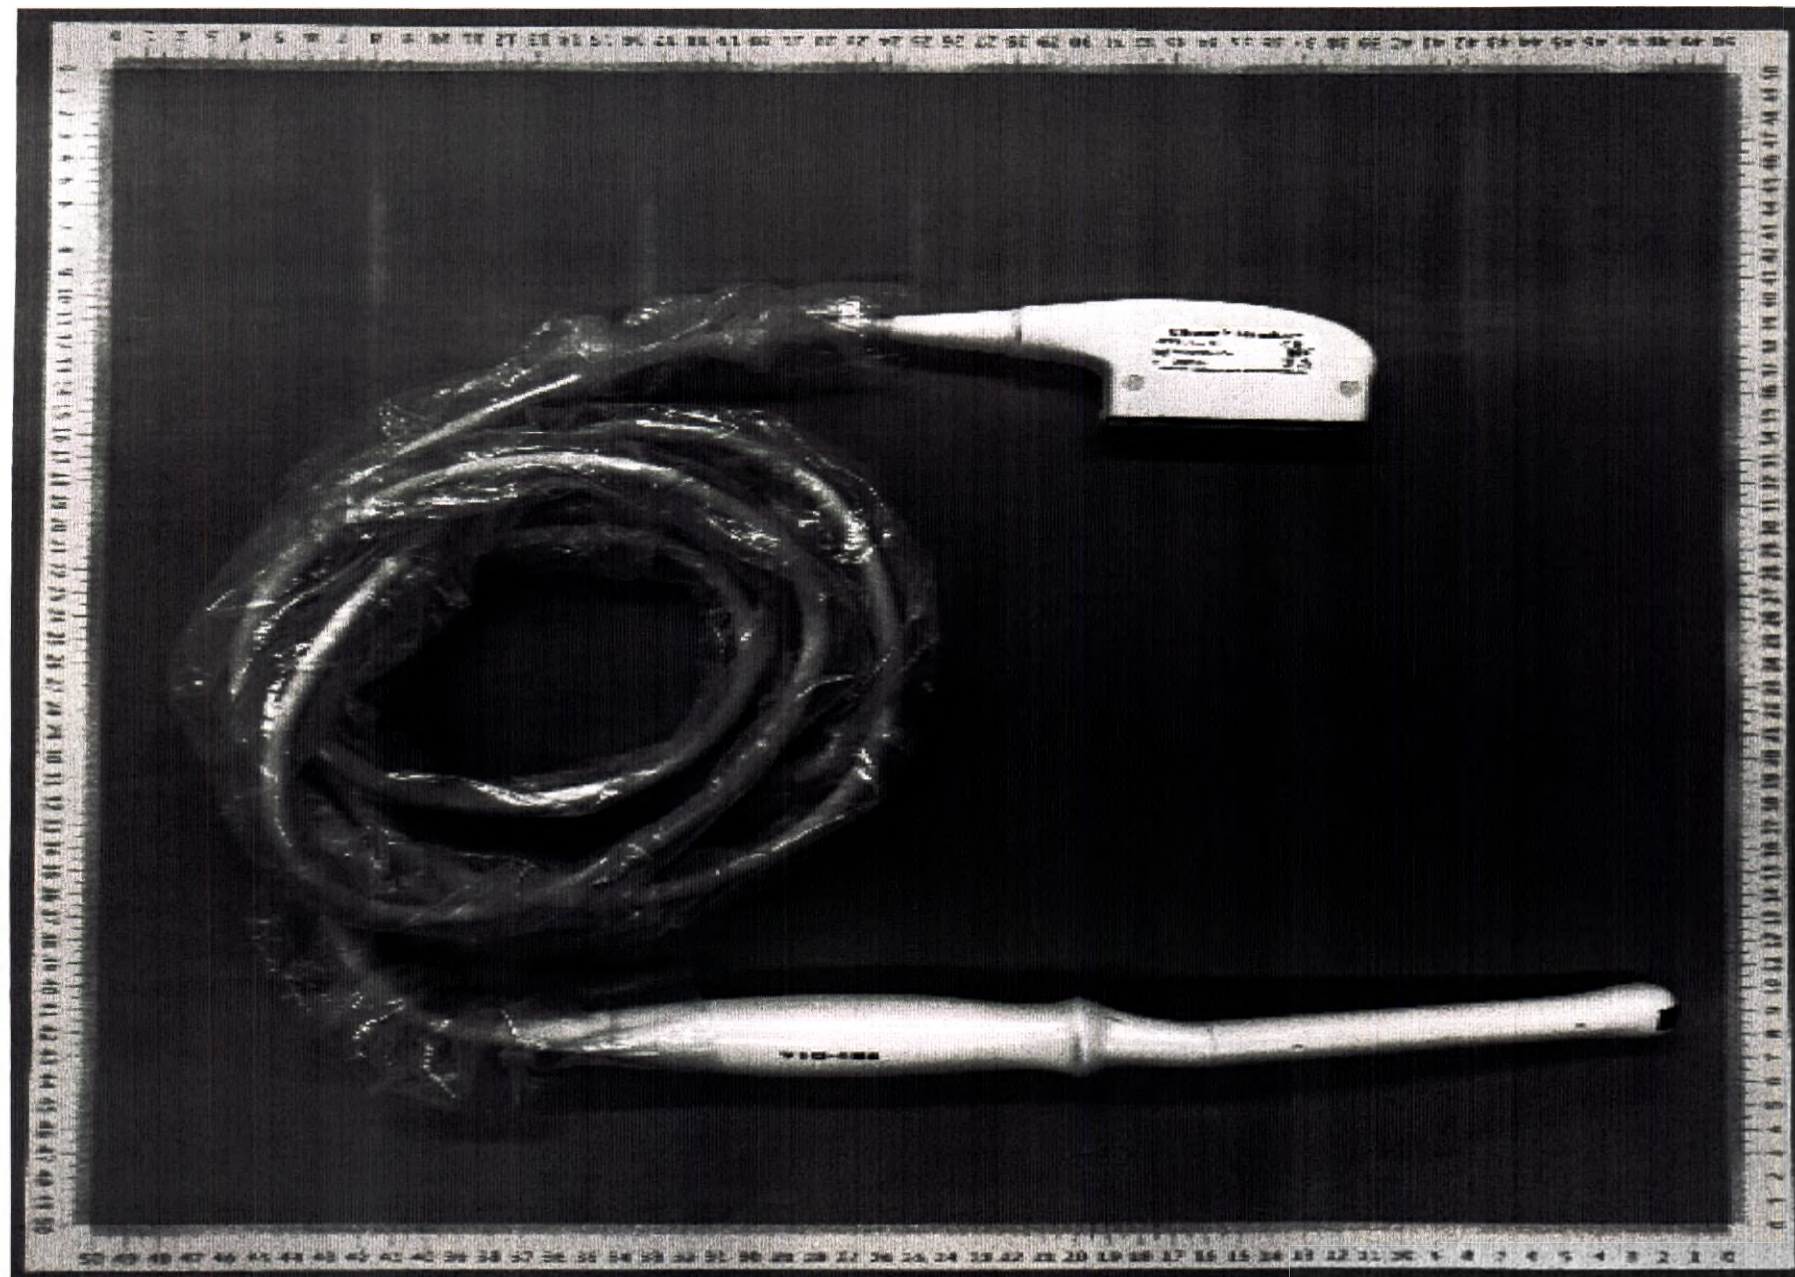


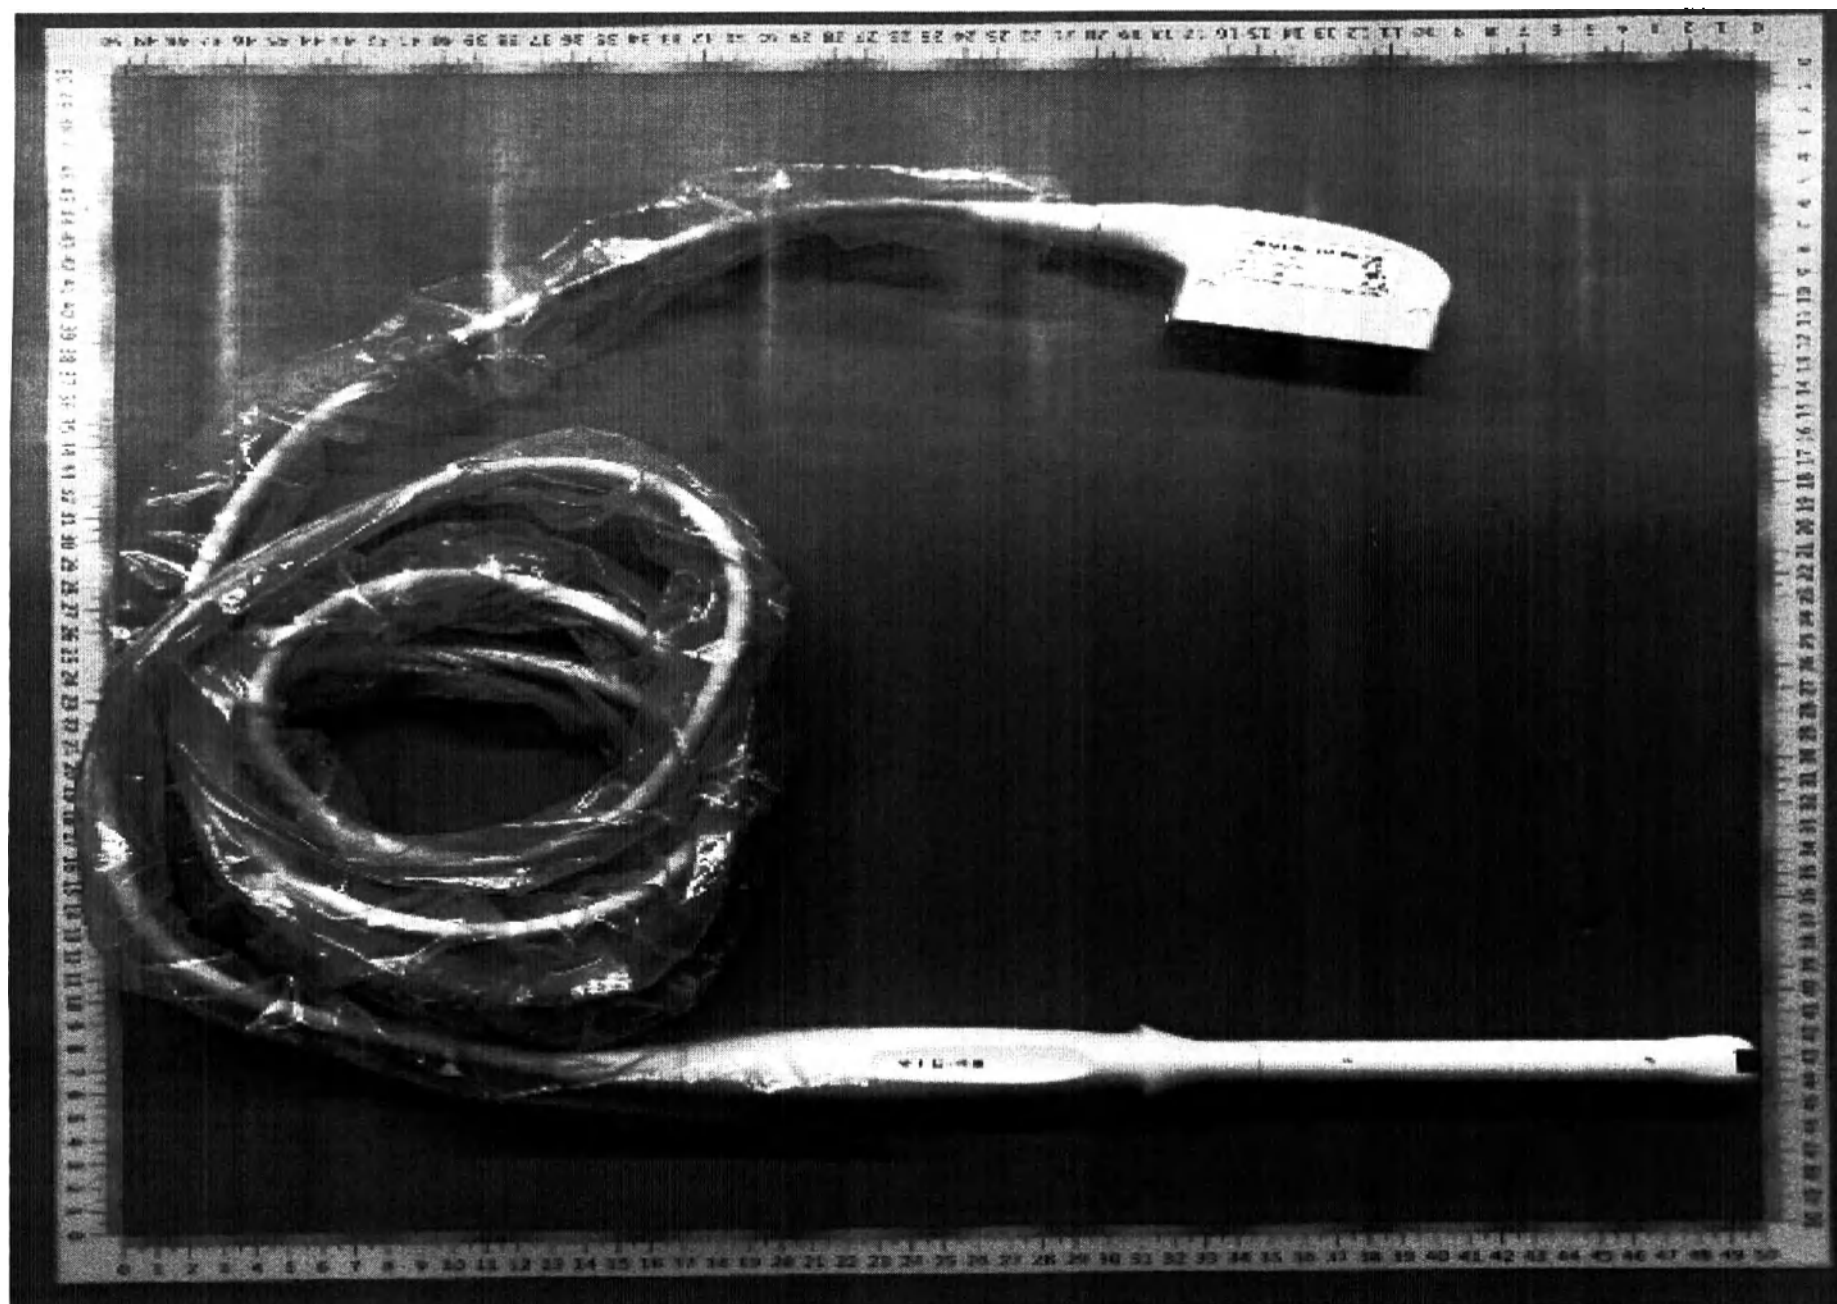


25. Насадки биопсийные, варианты исполнения

25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

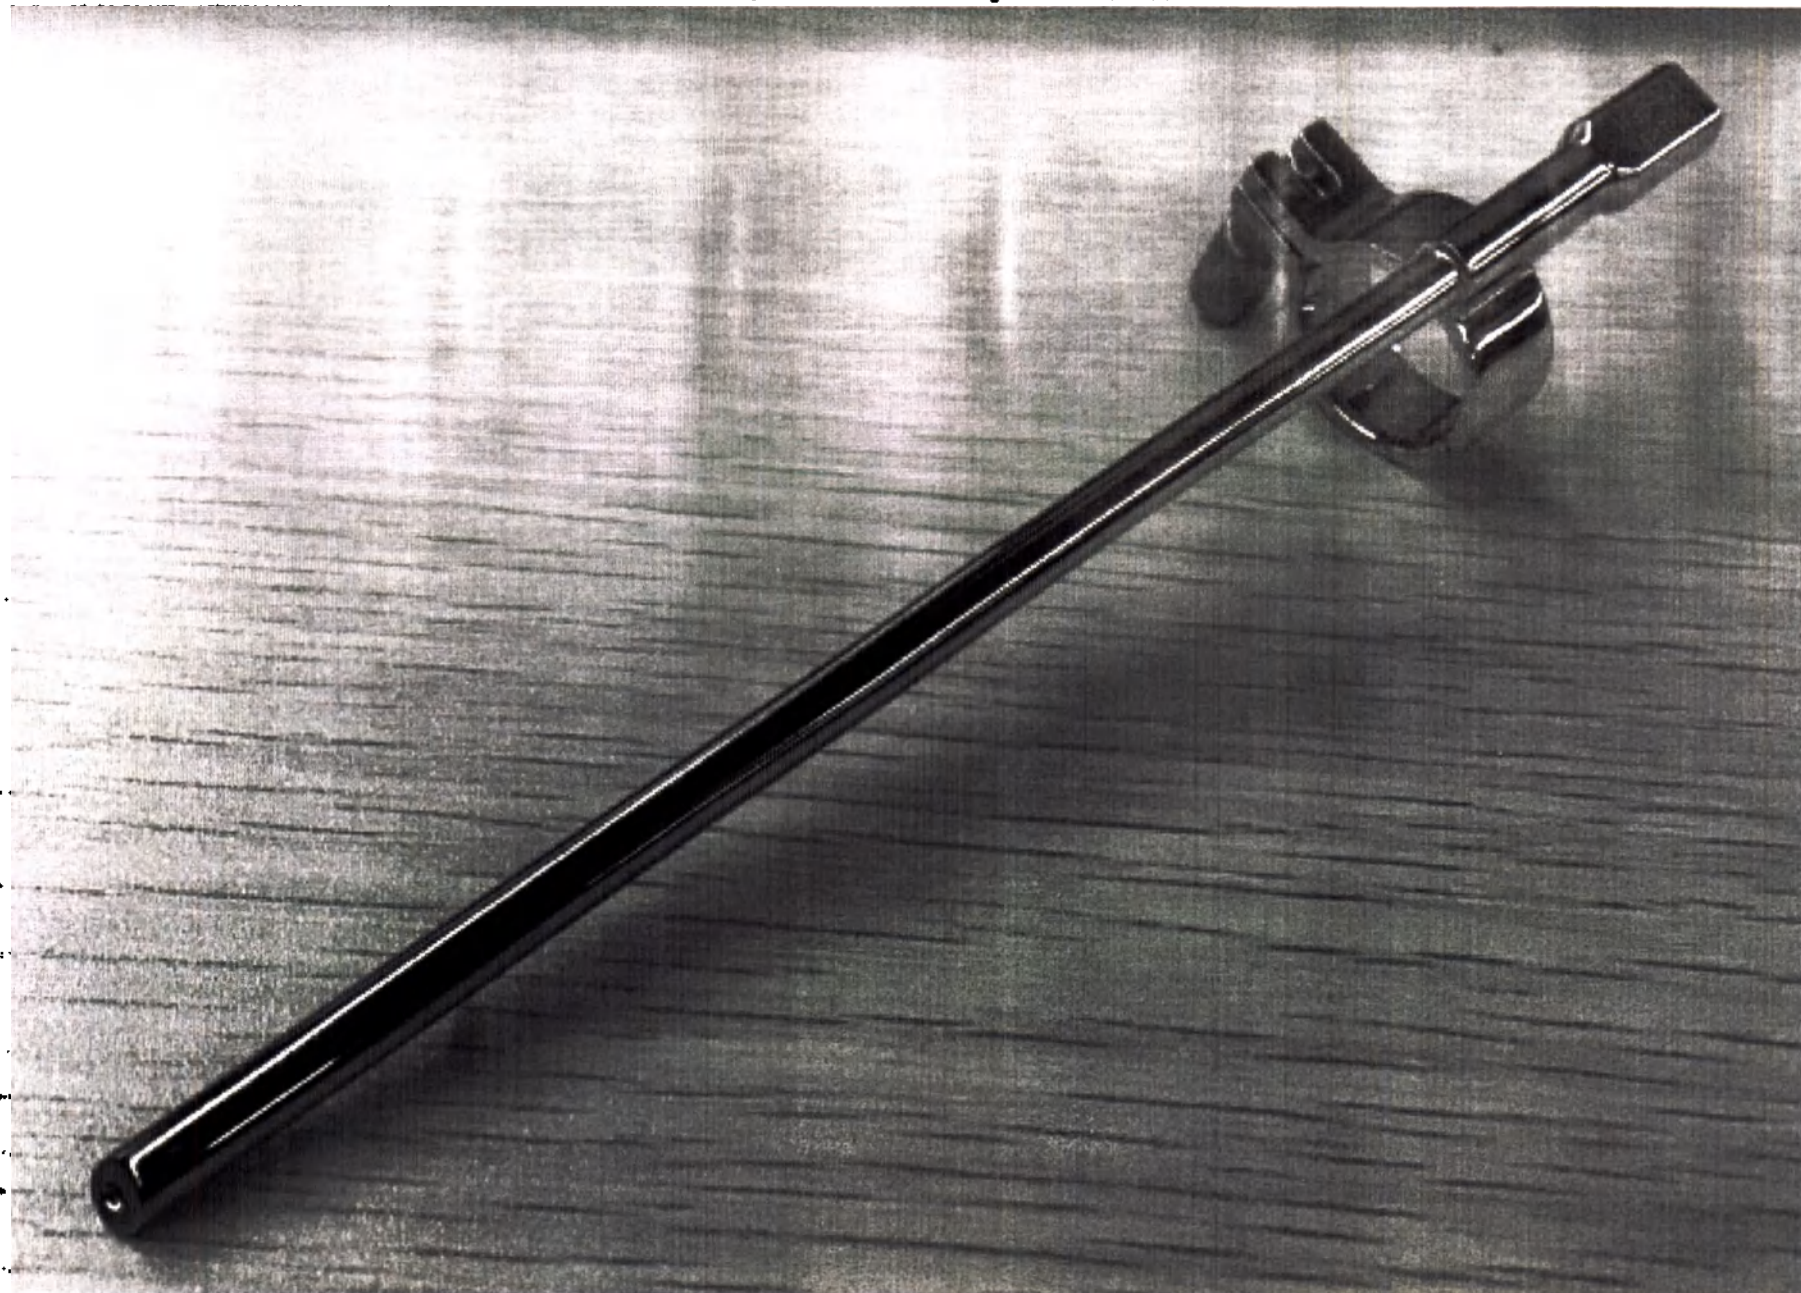


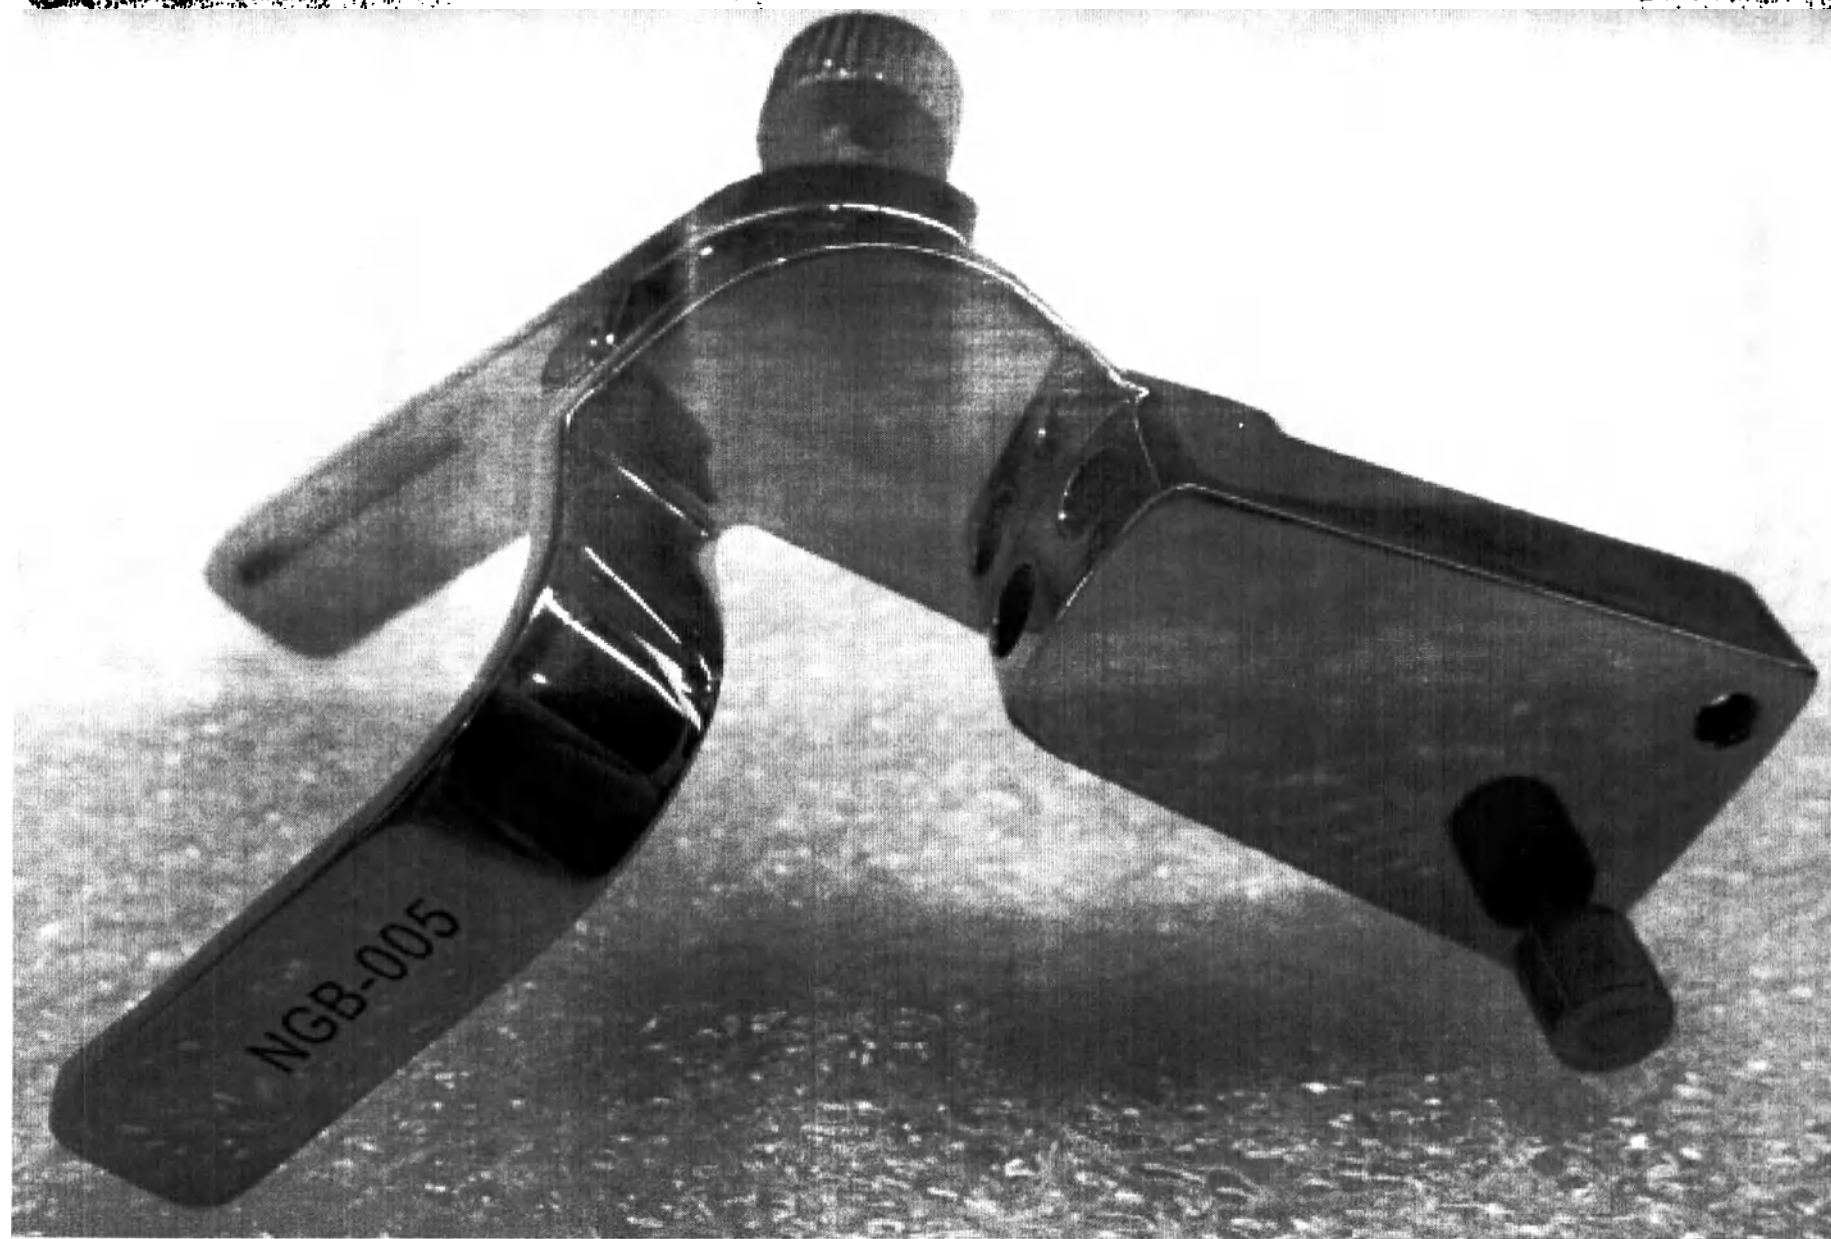





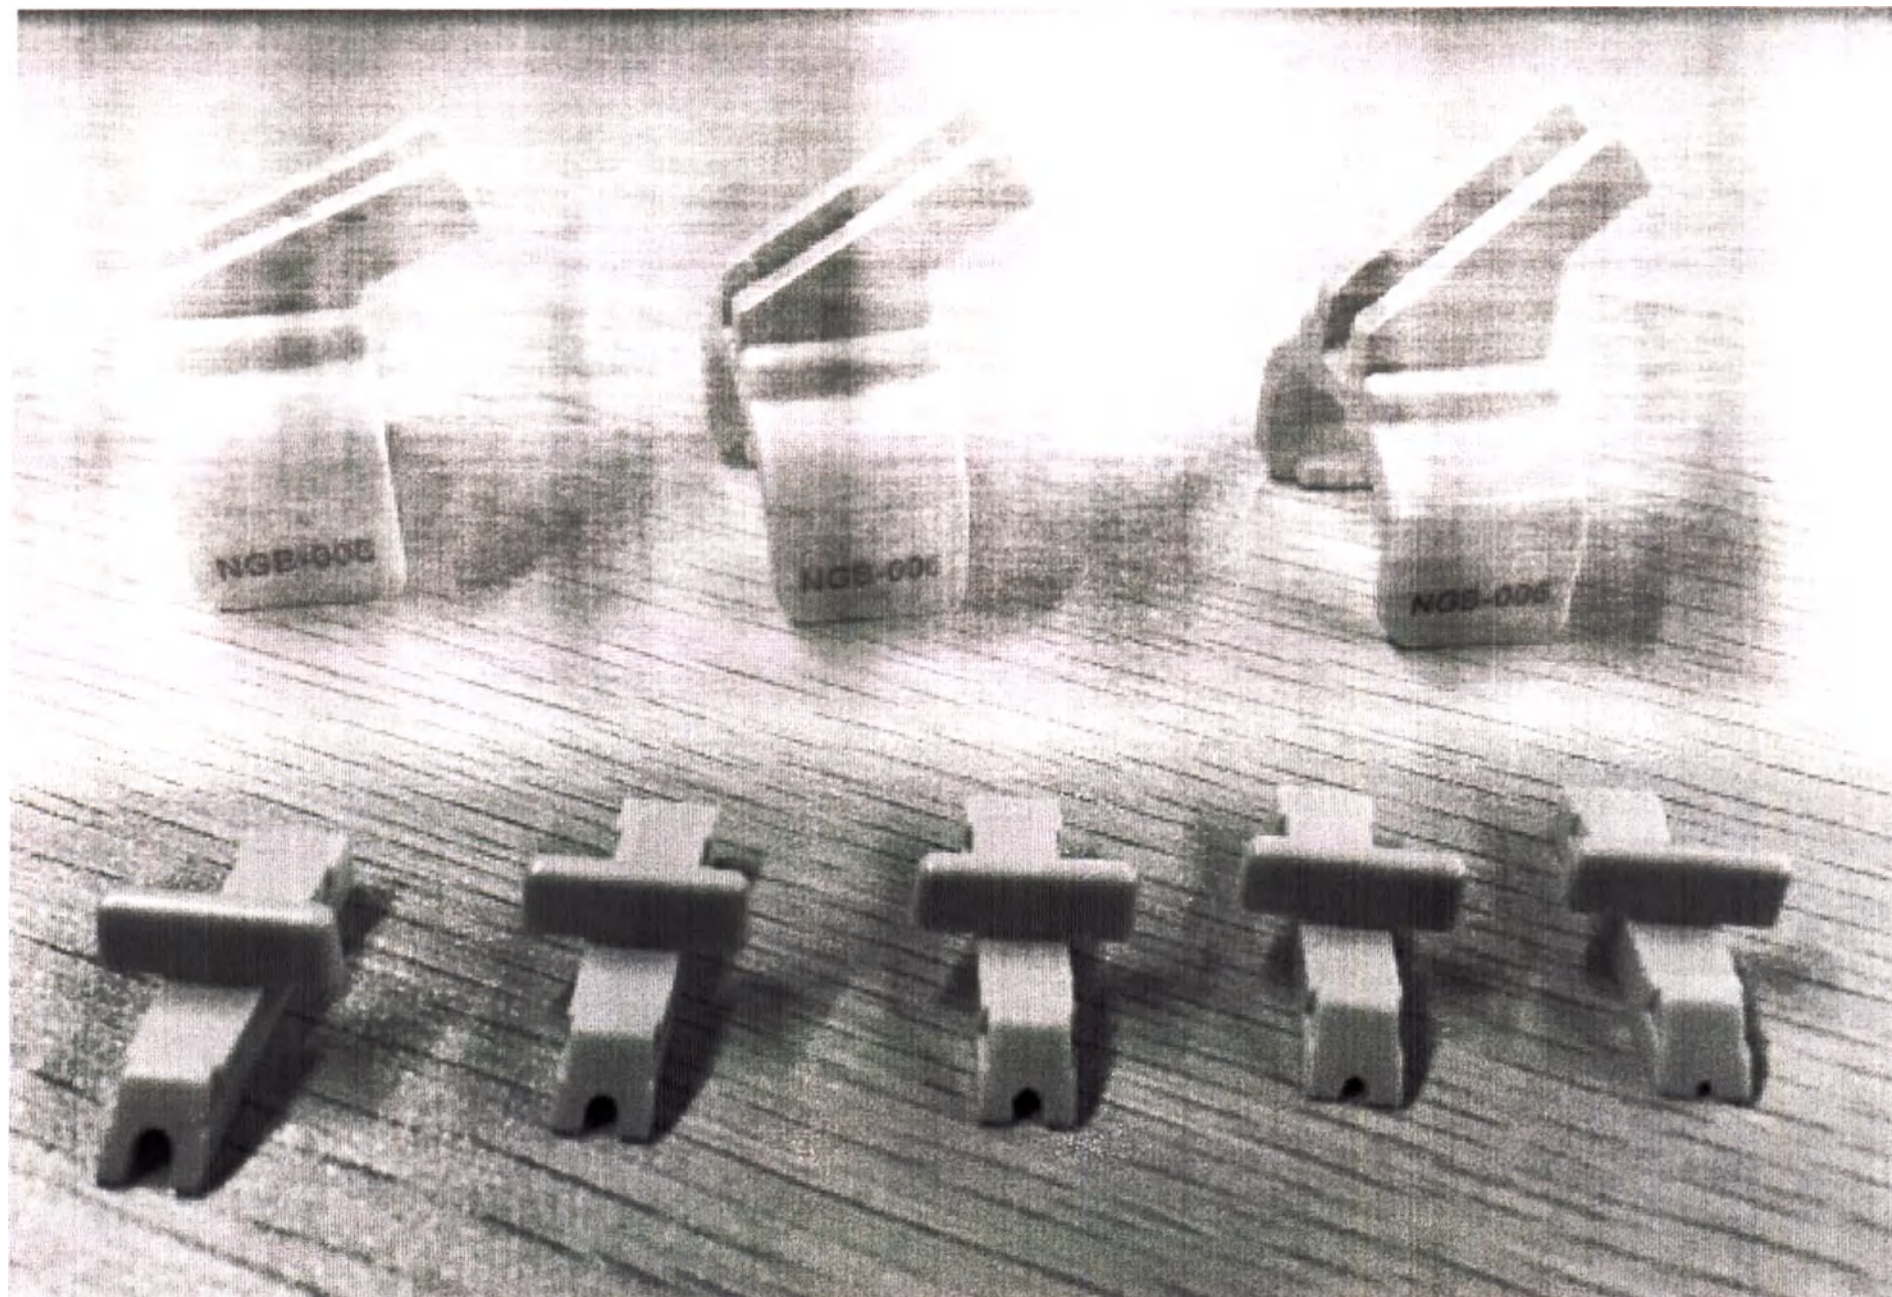




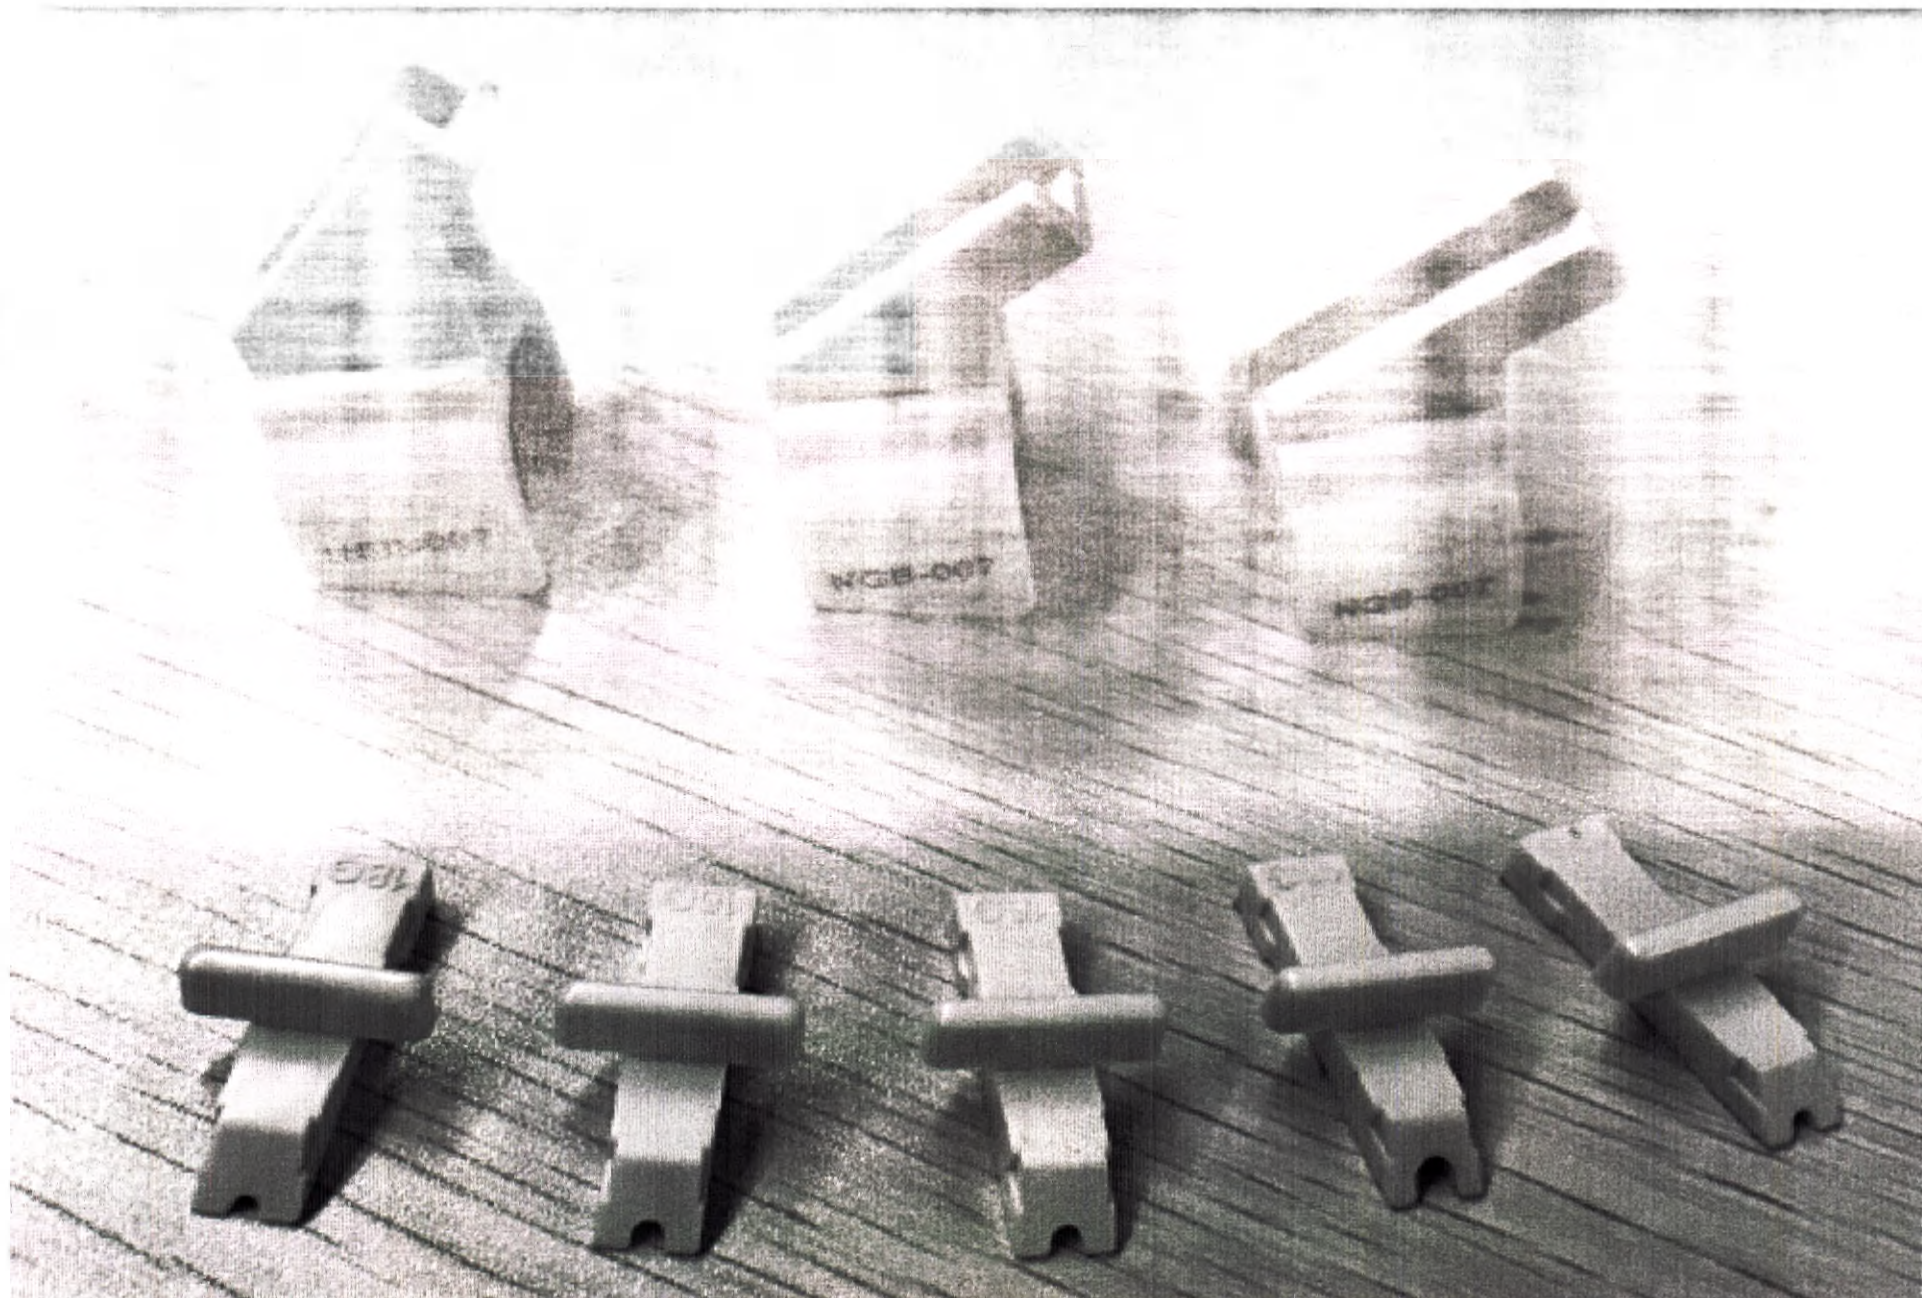

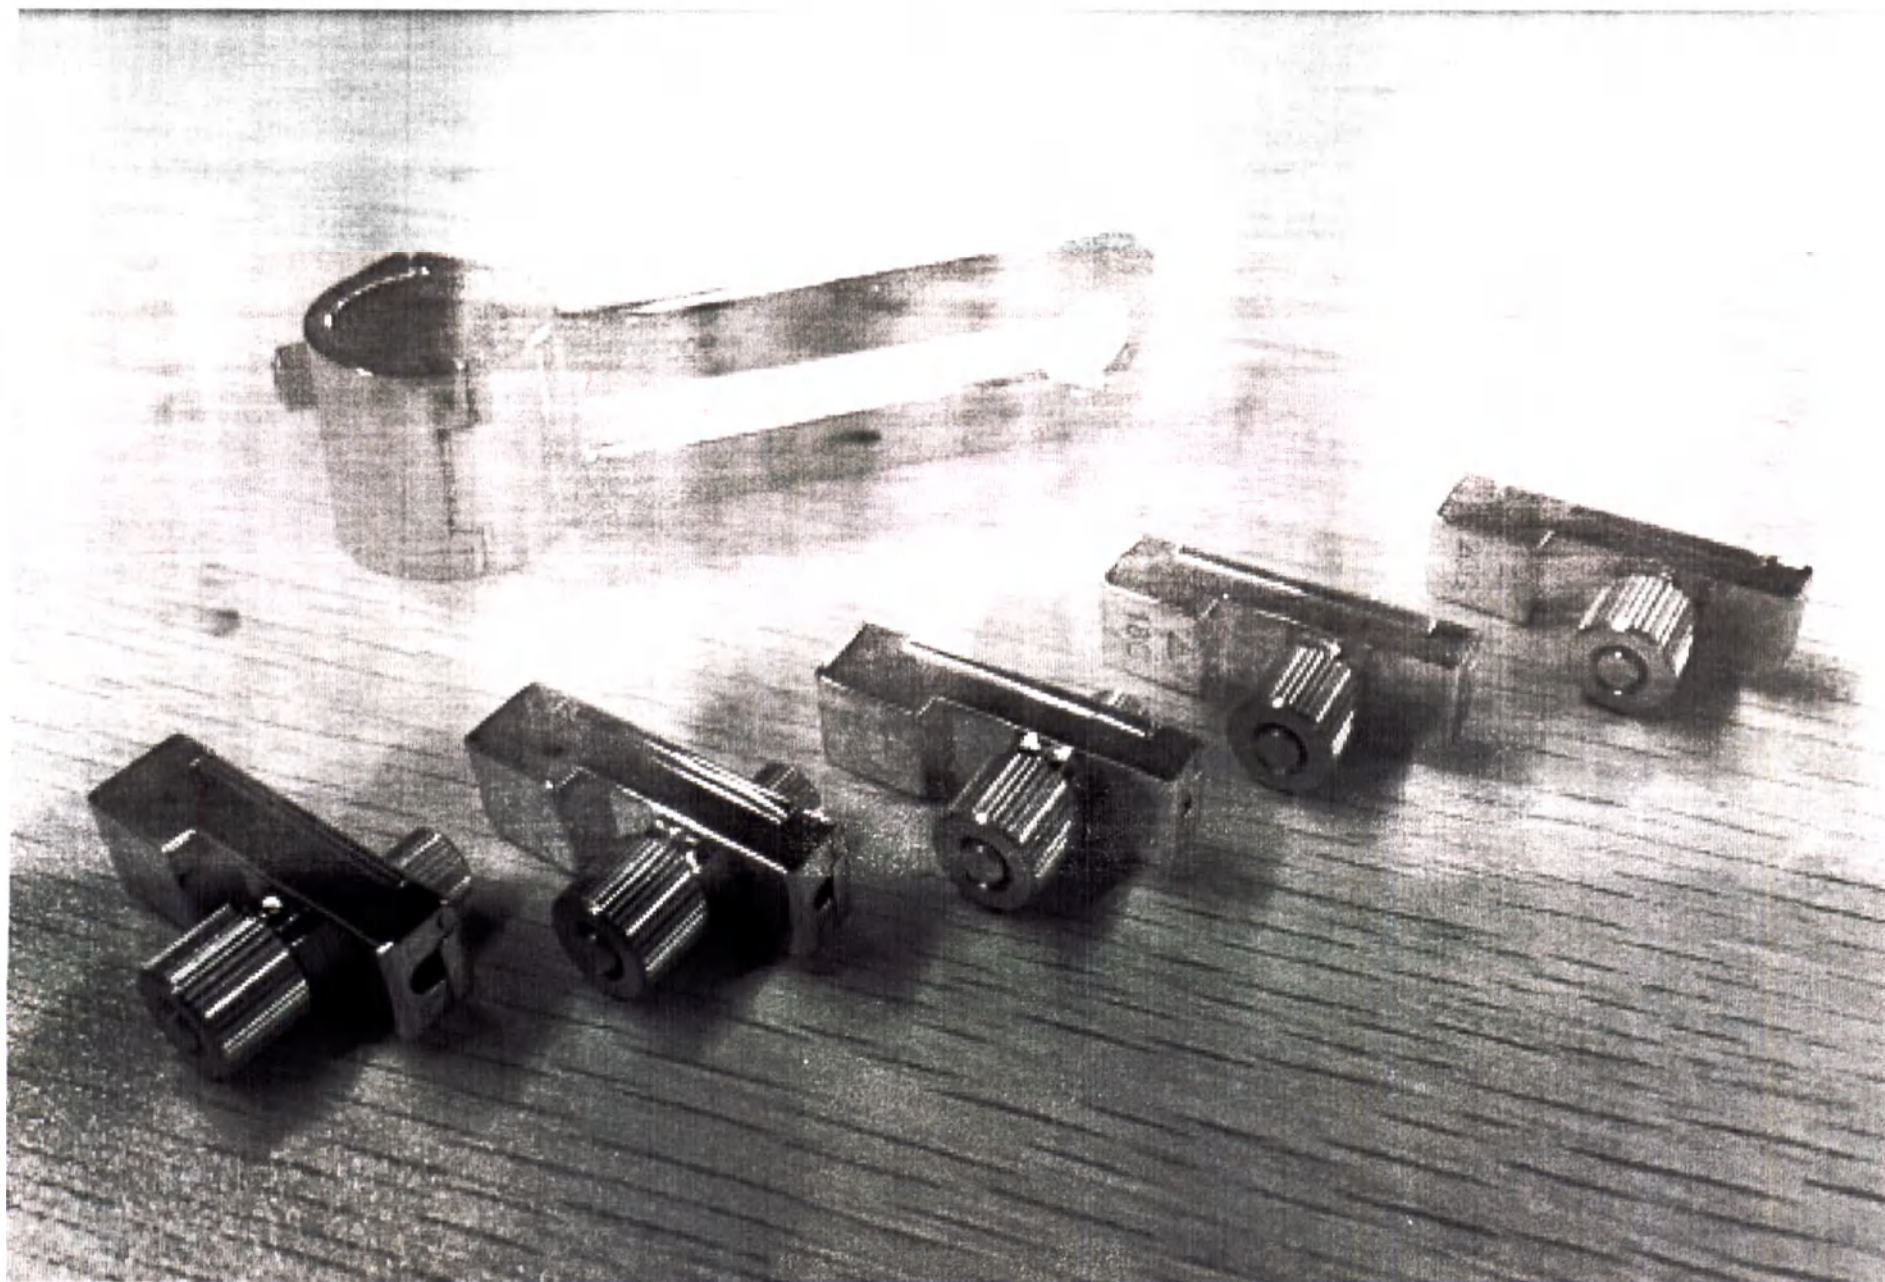


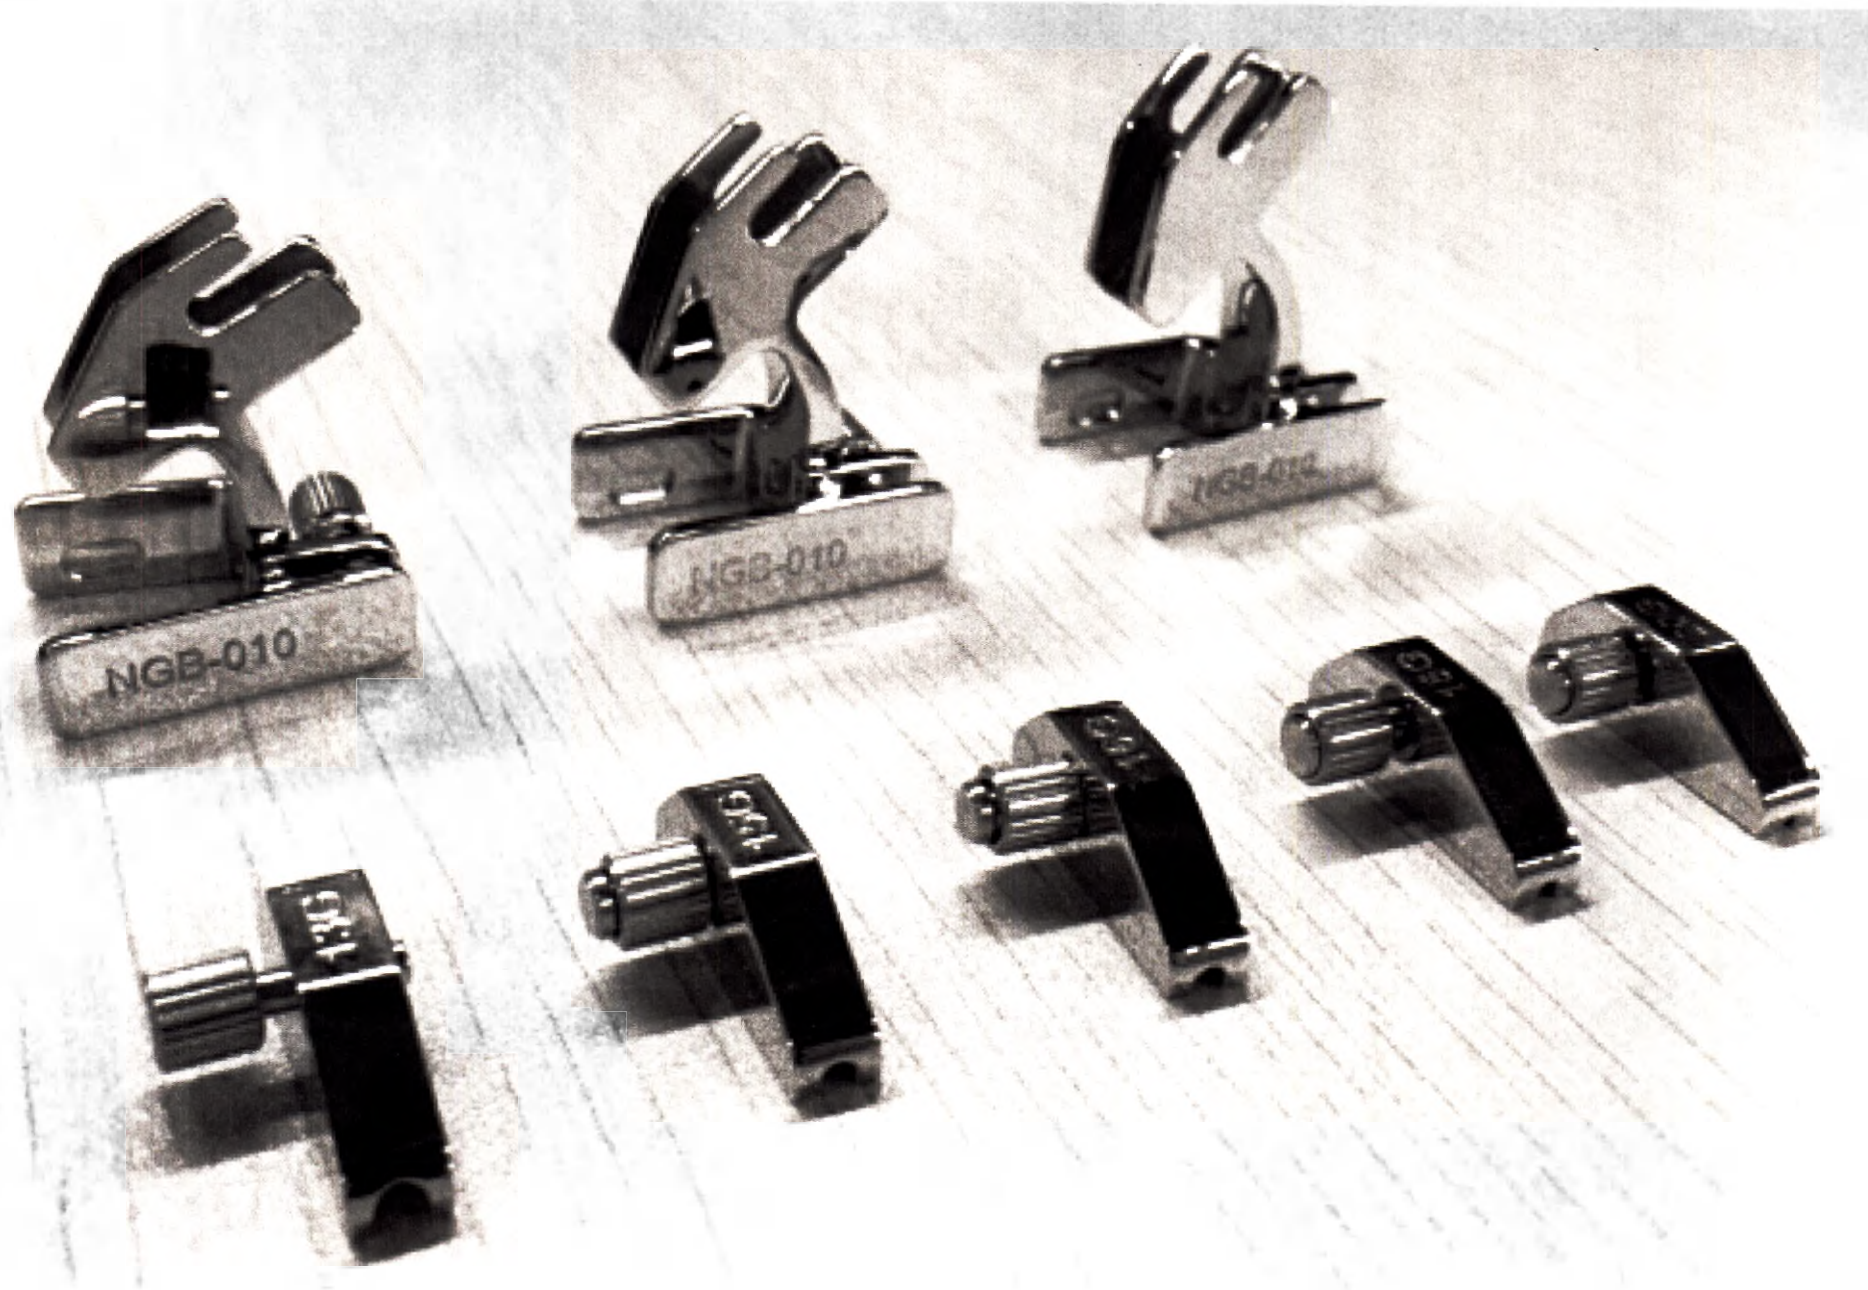

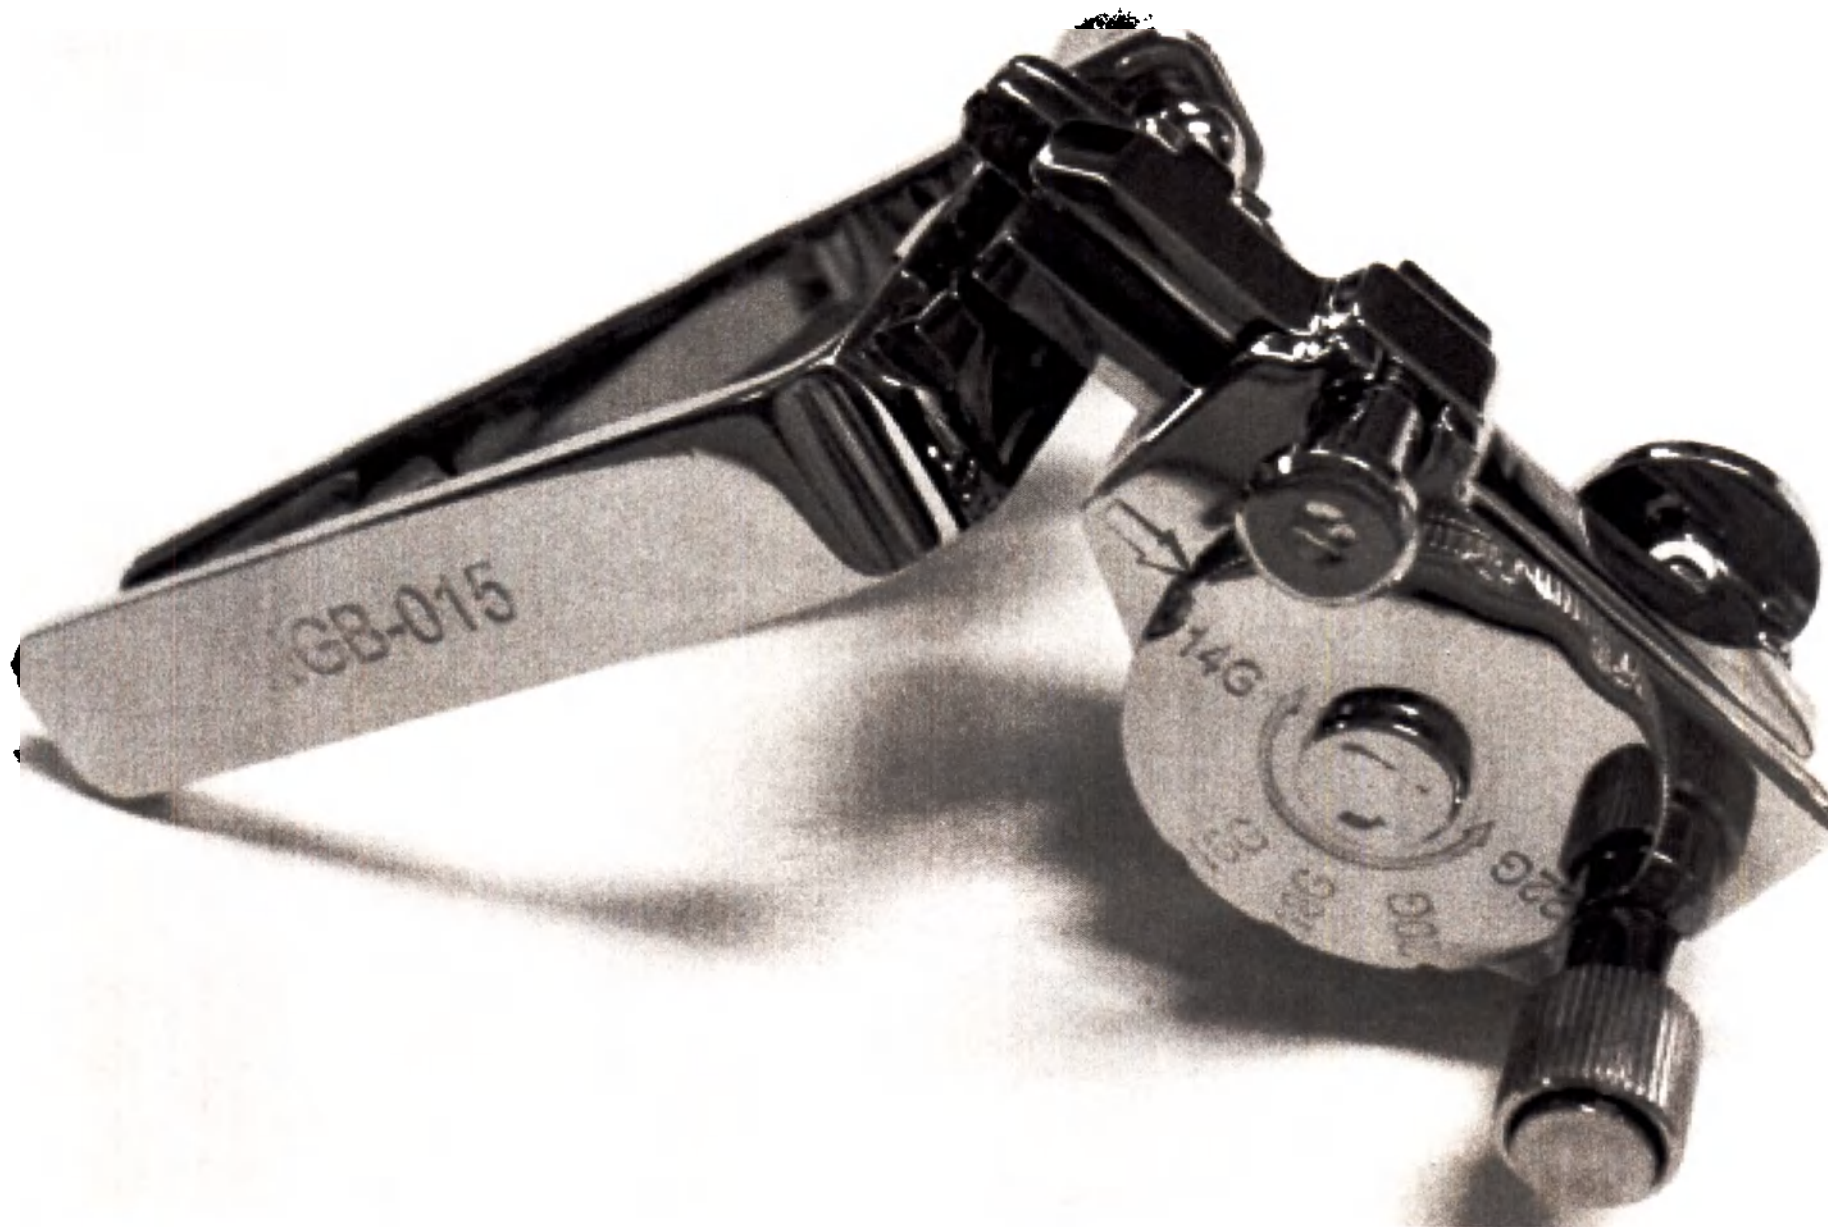




25.11. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018

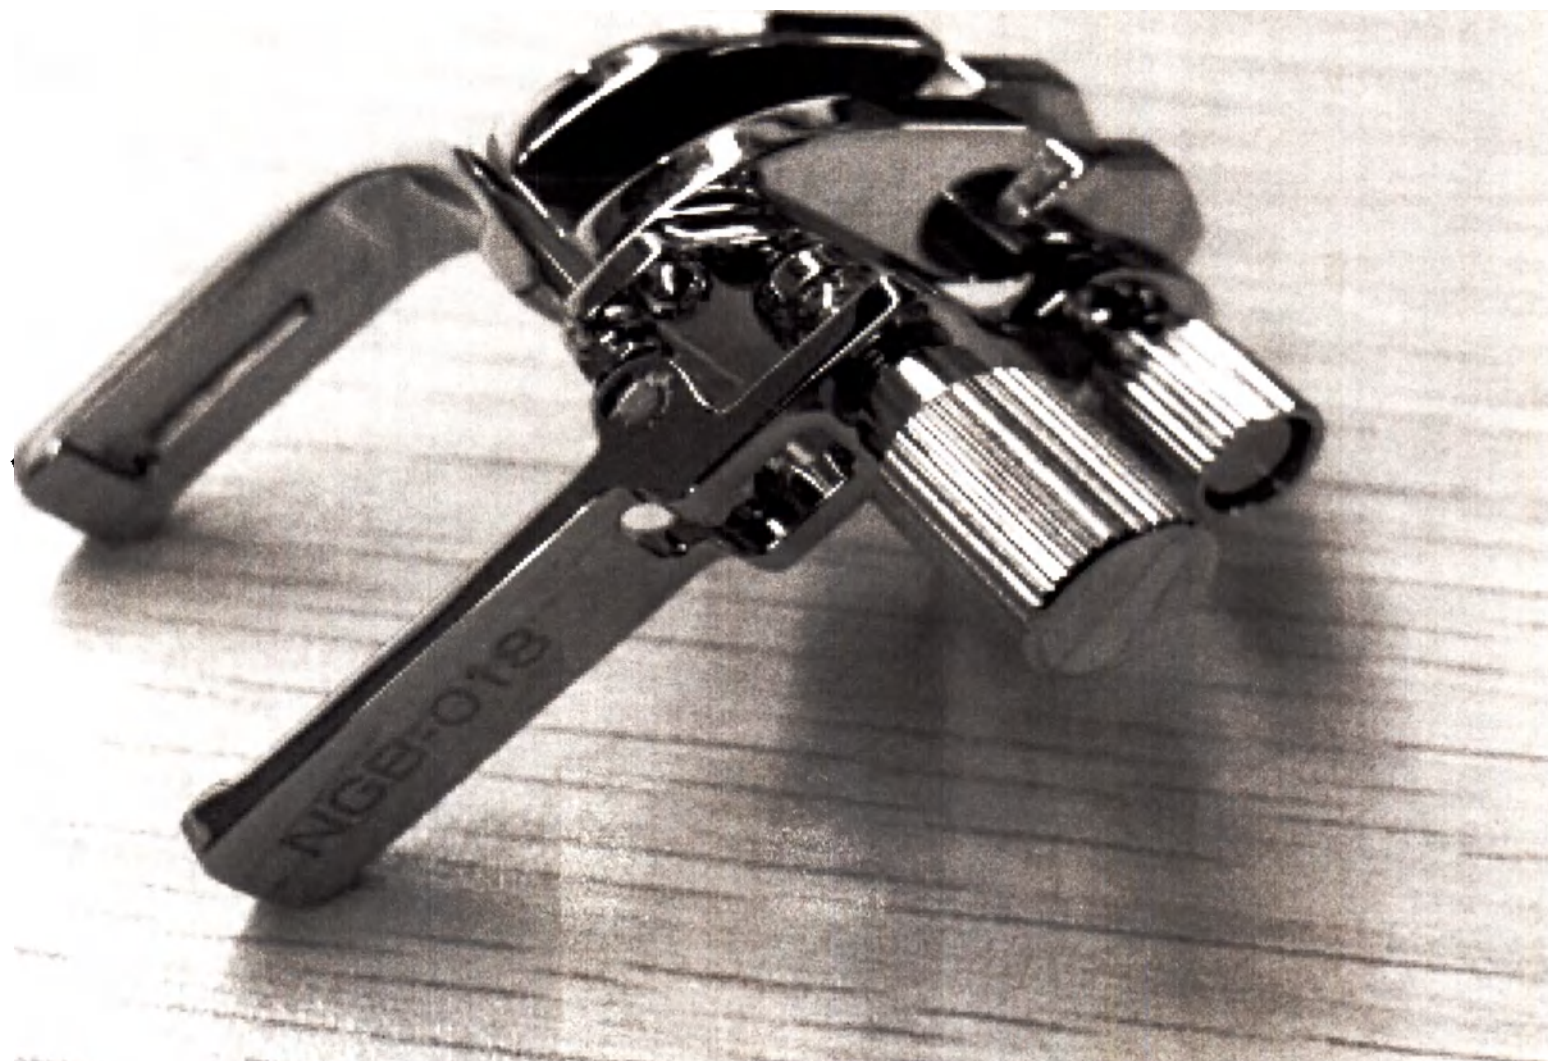

26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)

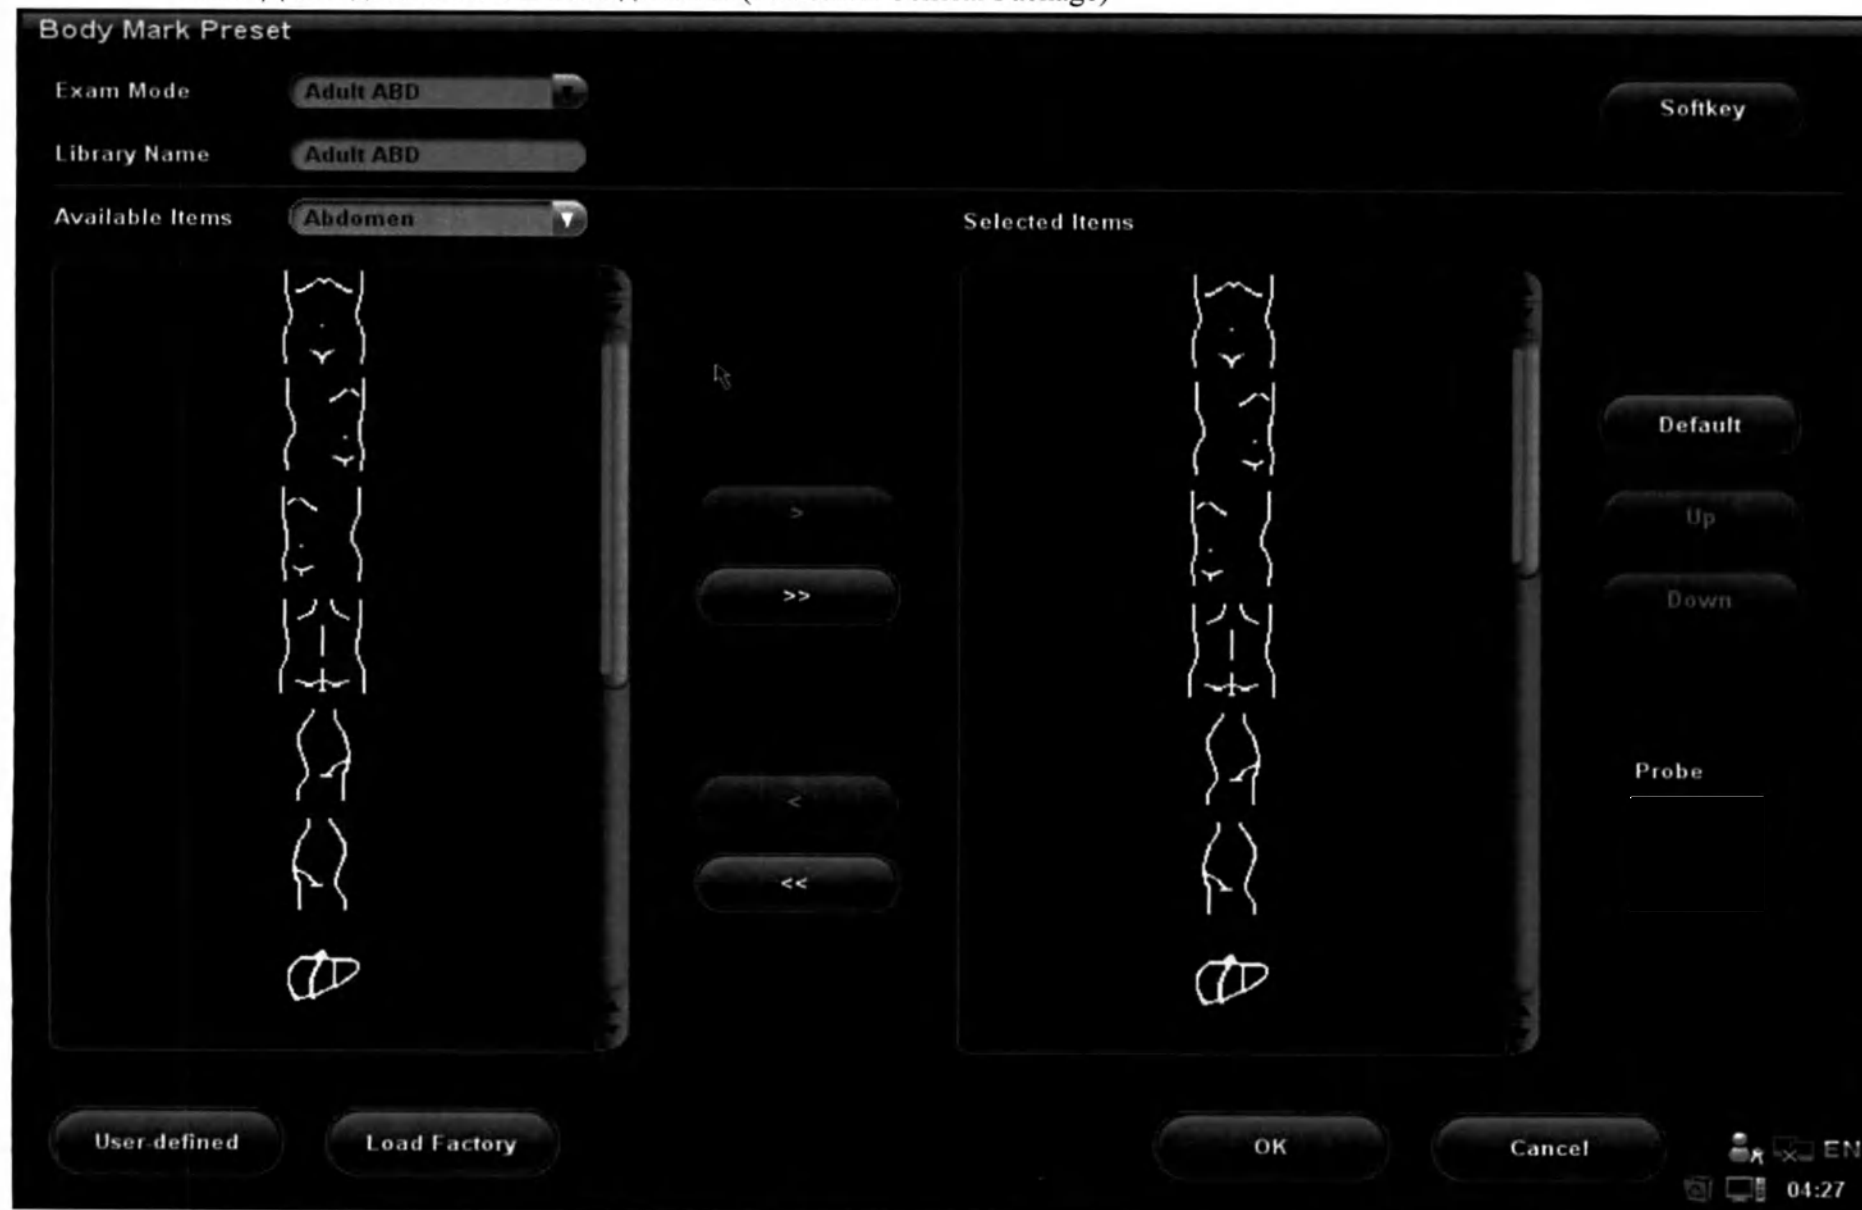


26.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package)




26.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package)



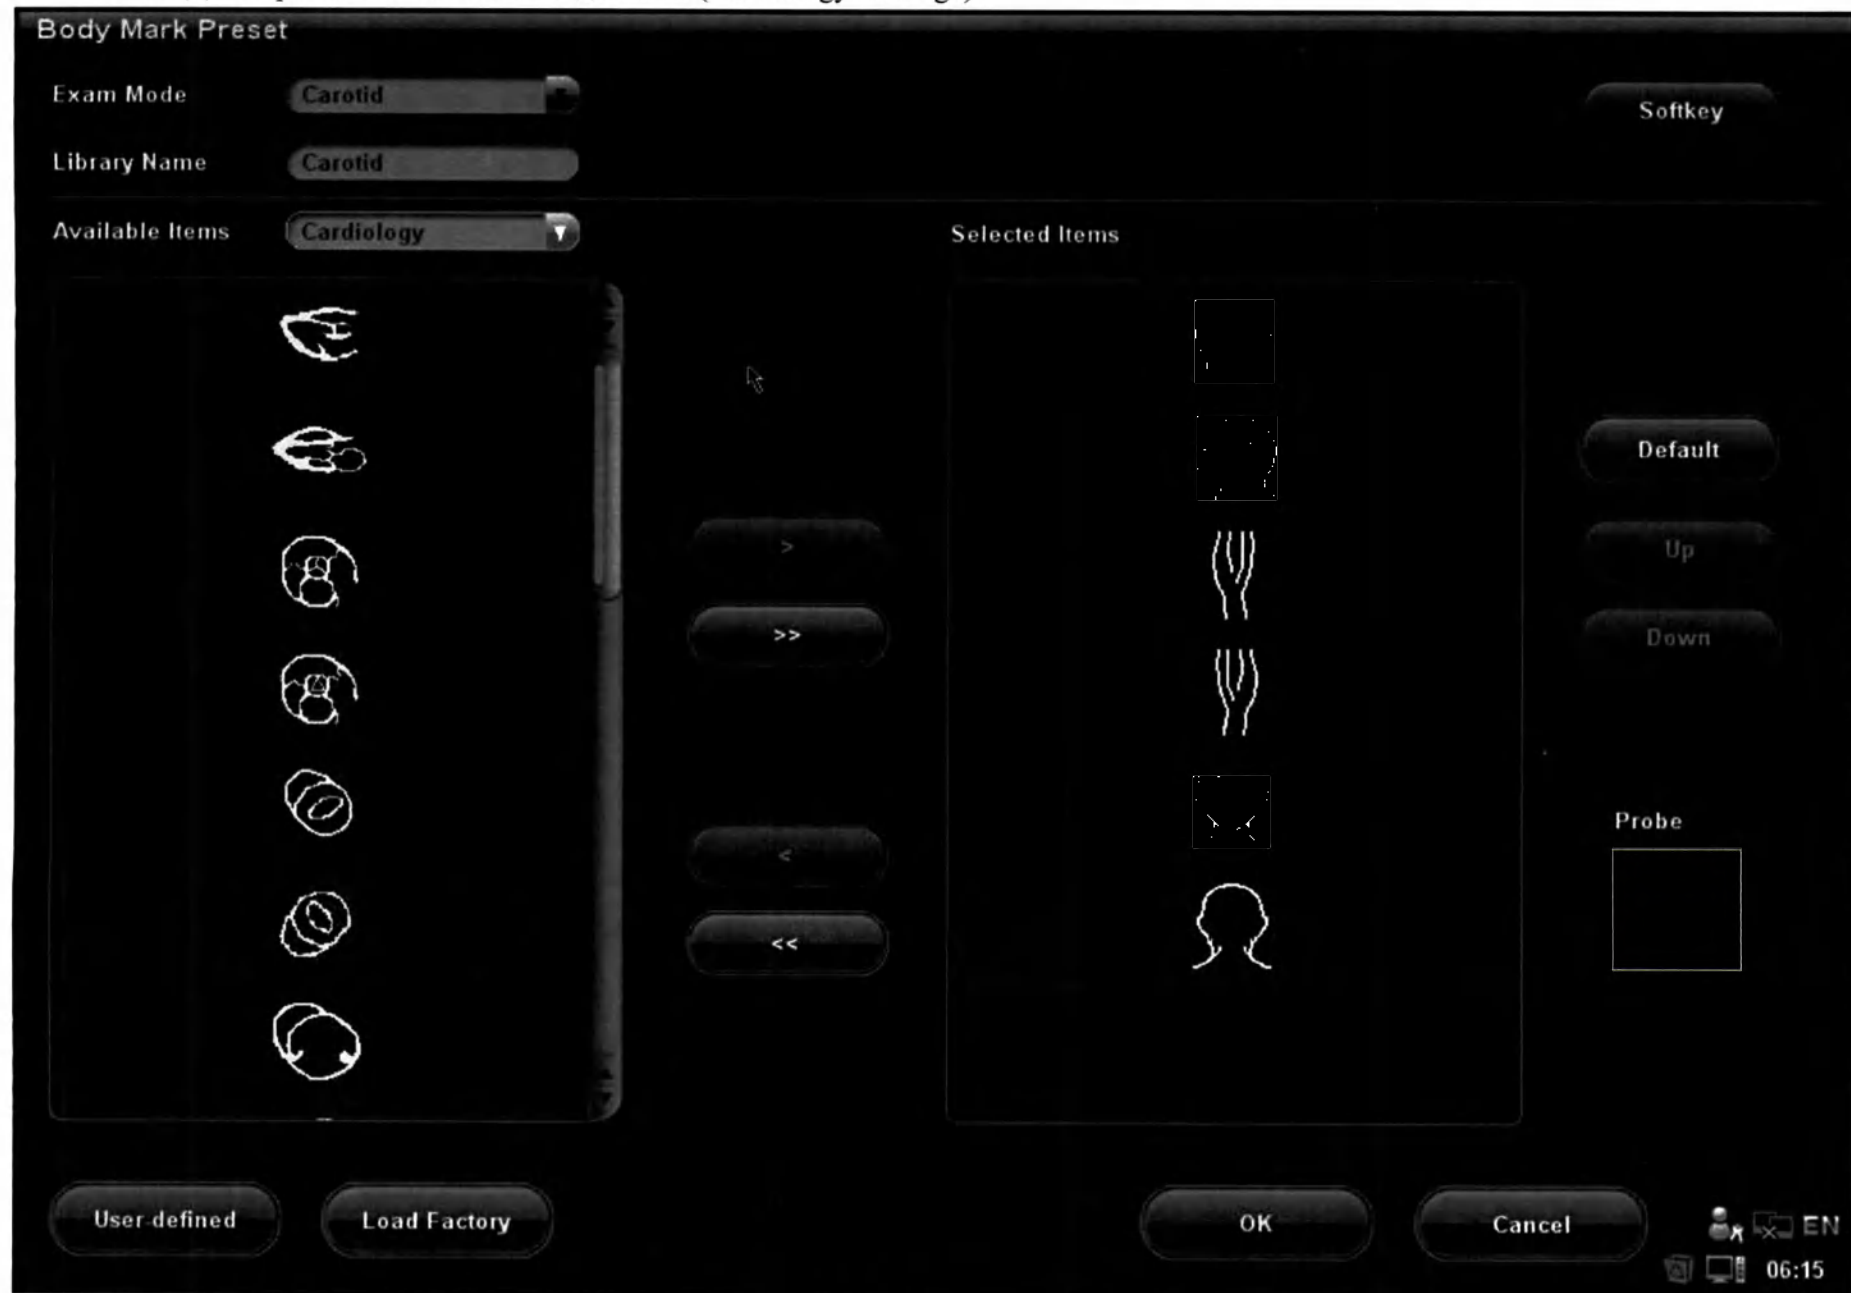



26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

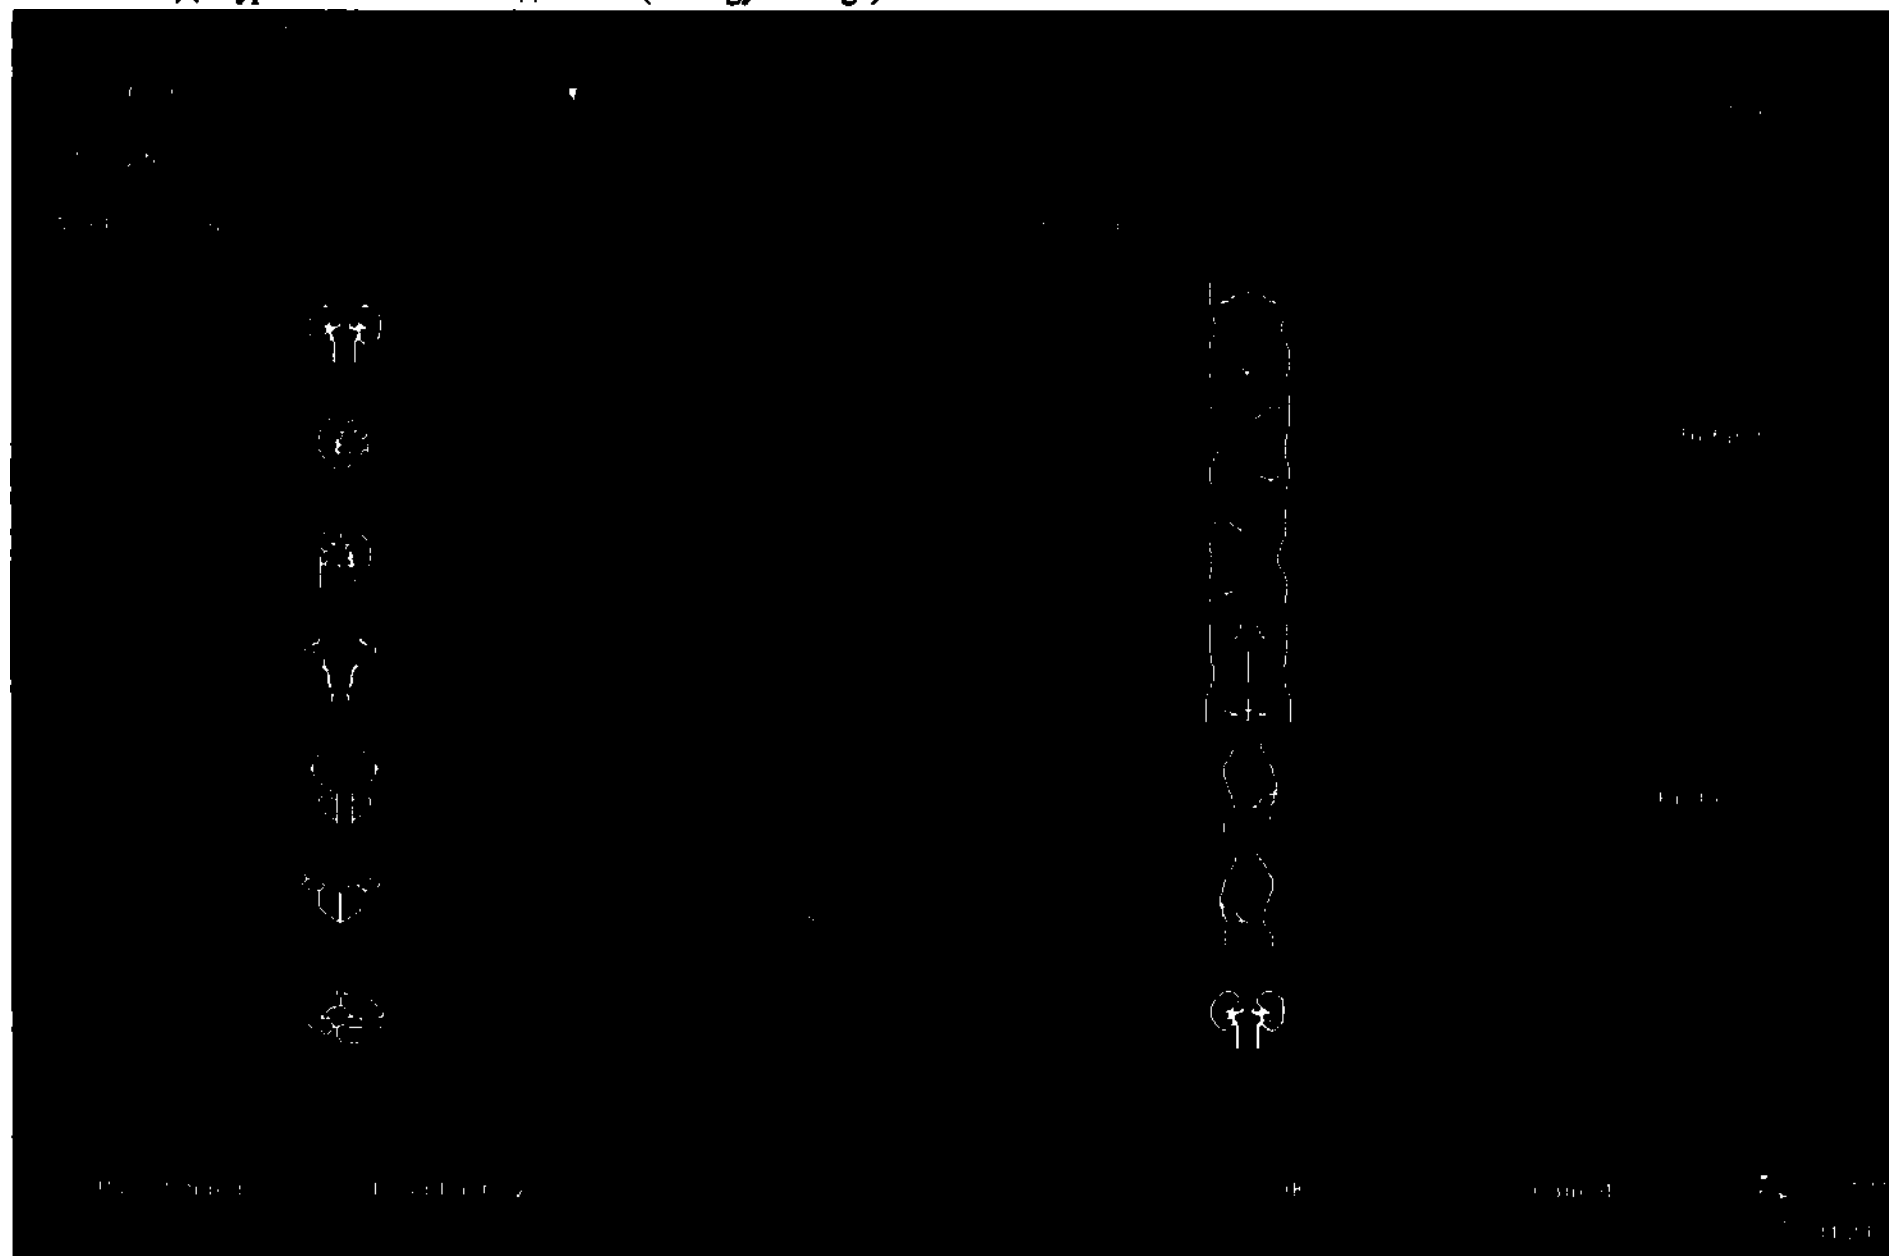

26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)






26.9. Для исследований нервов (Nerve Package)







26.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)

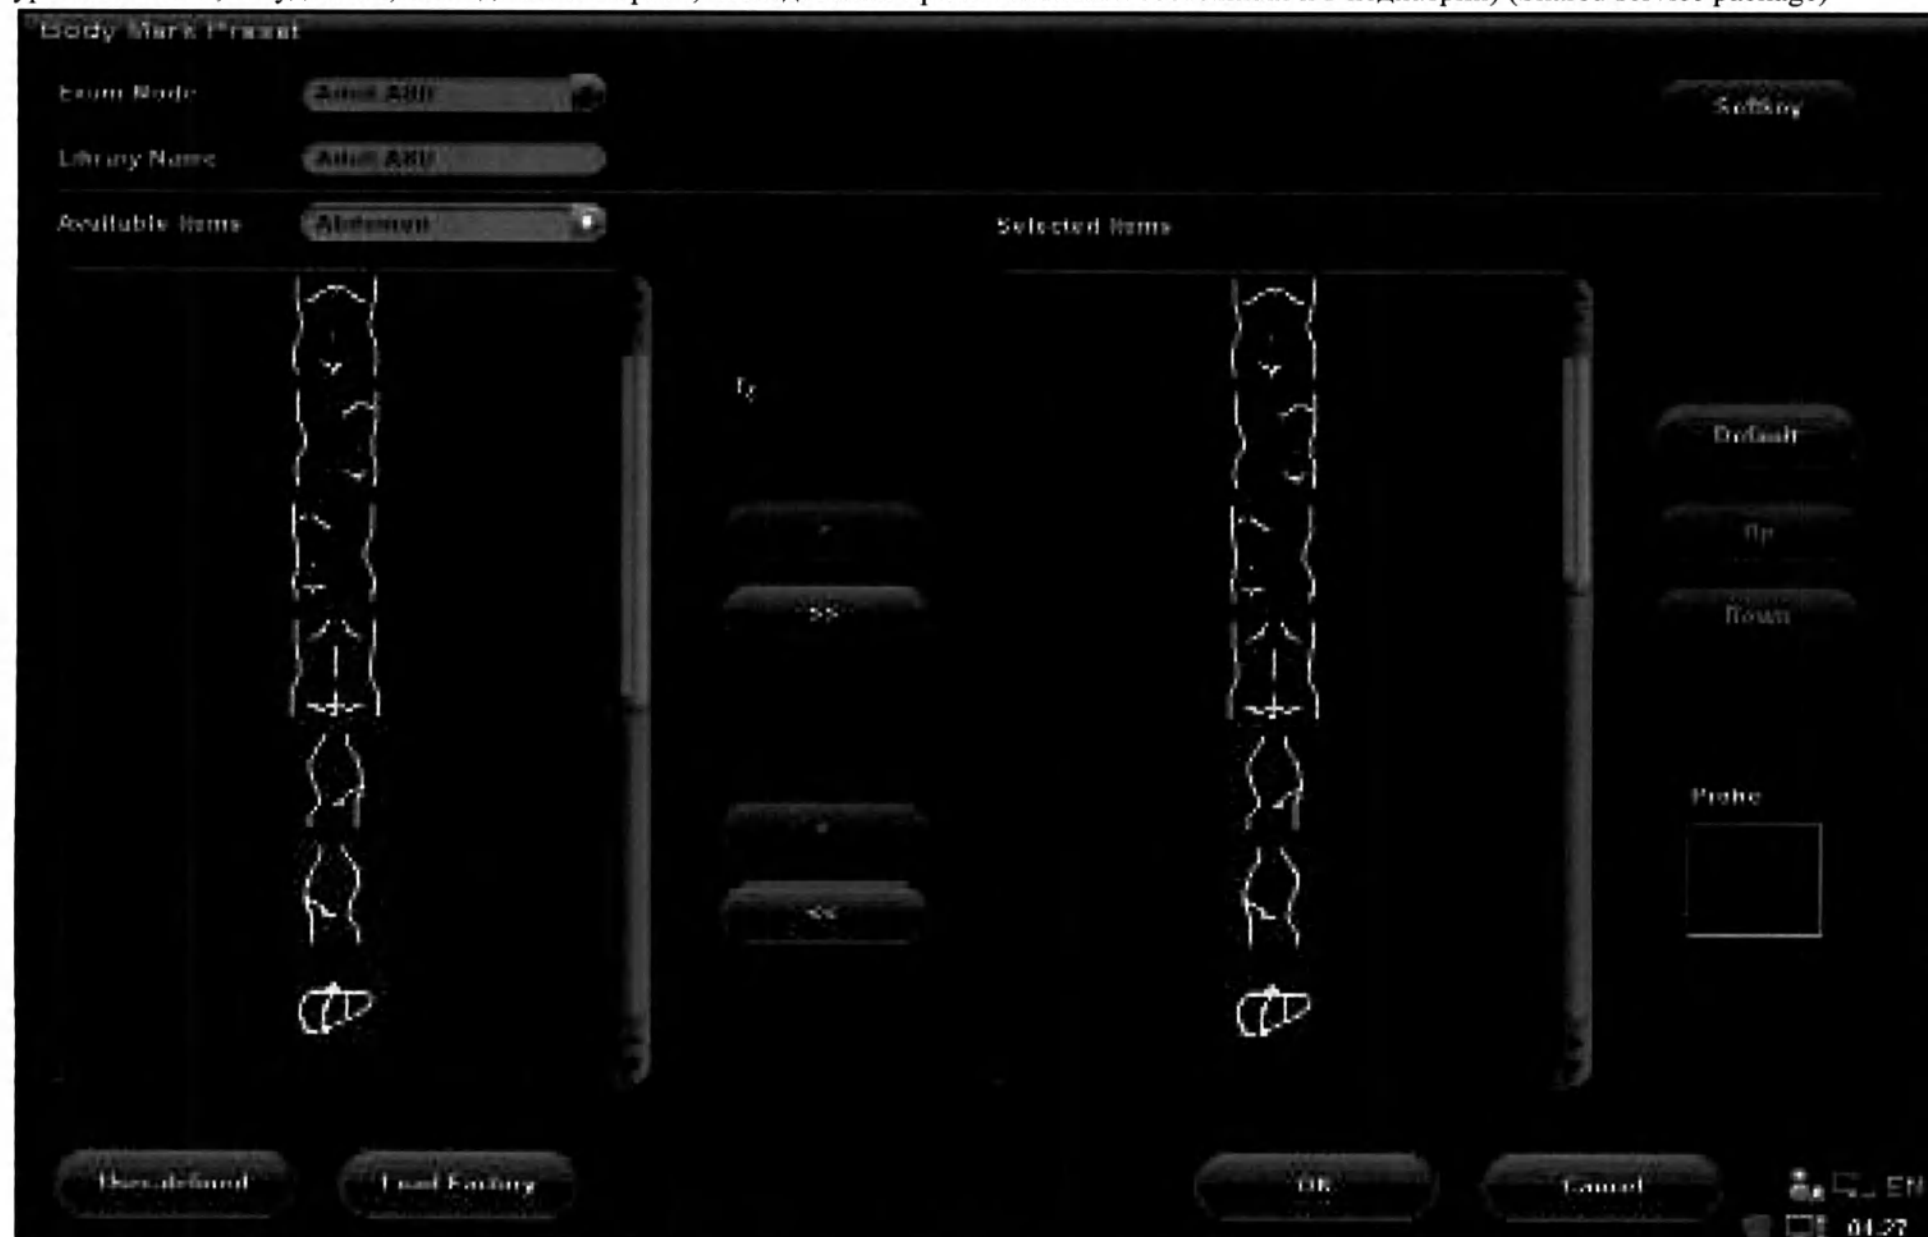




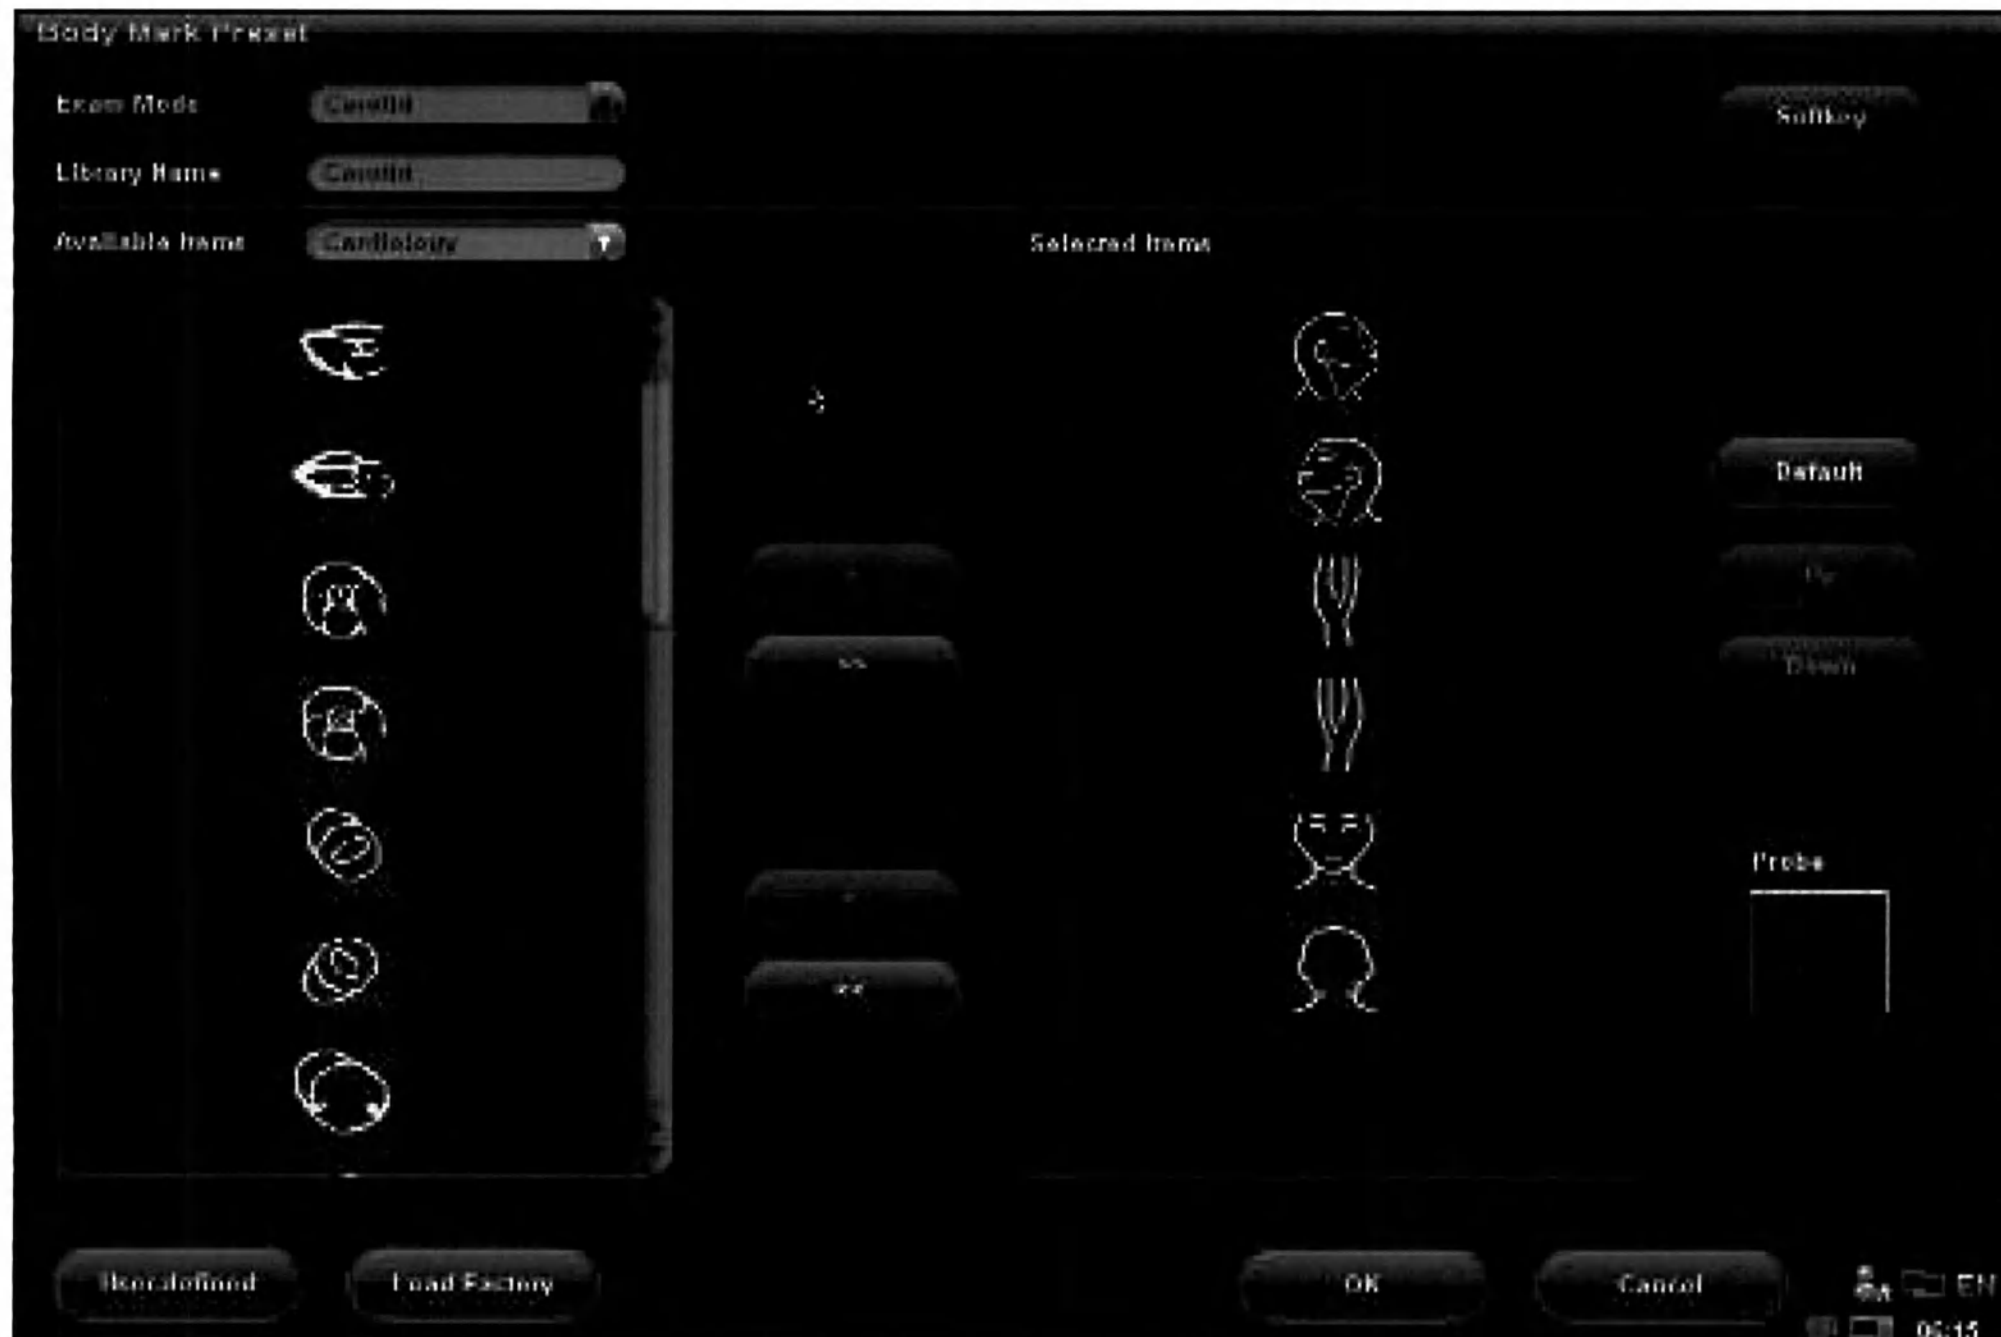




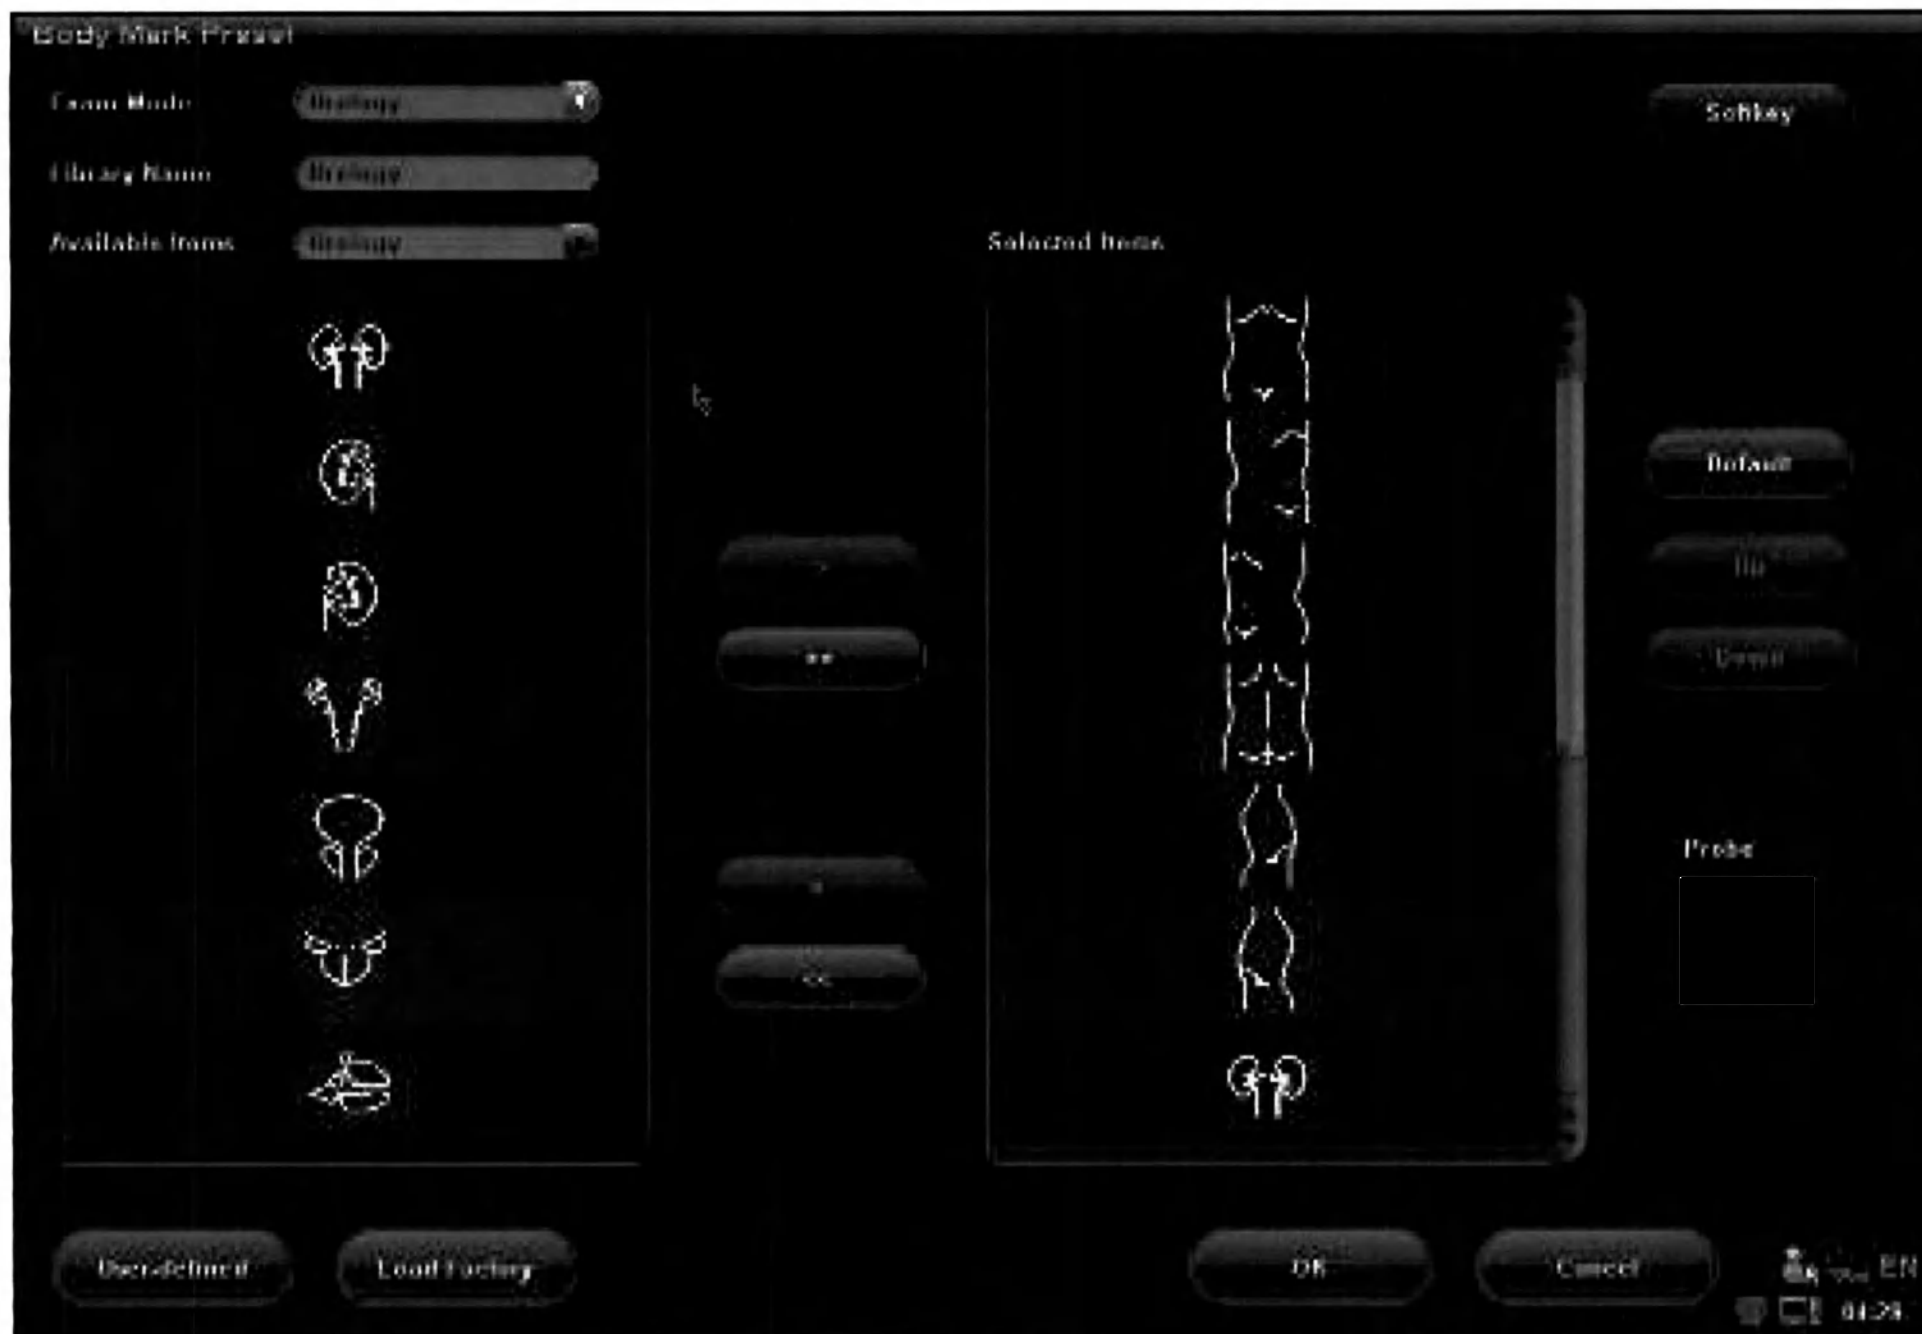

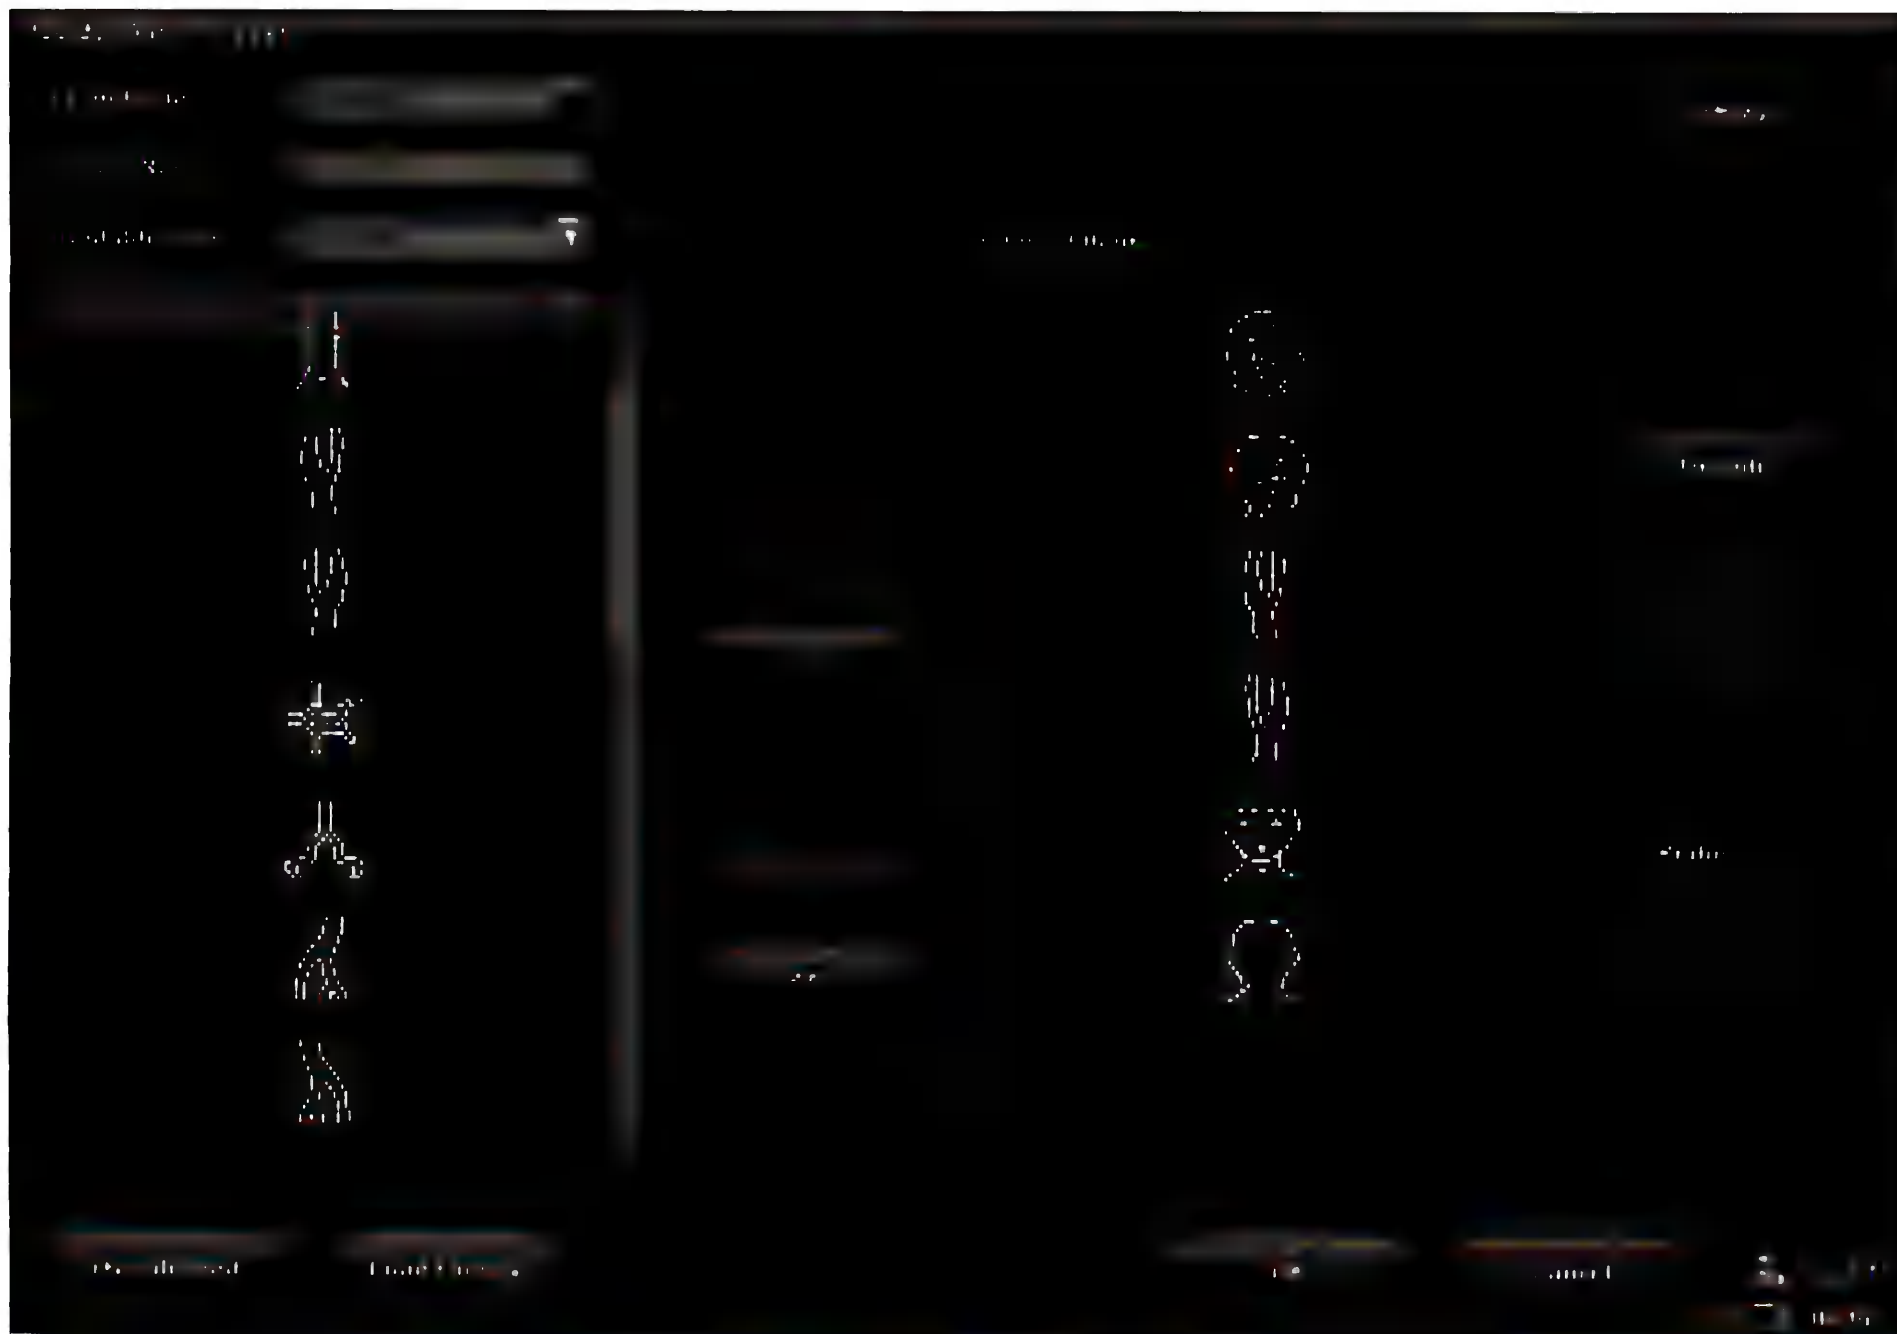





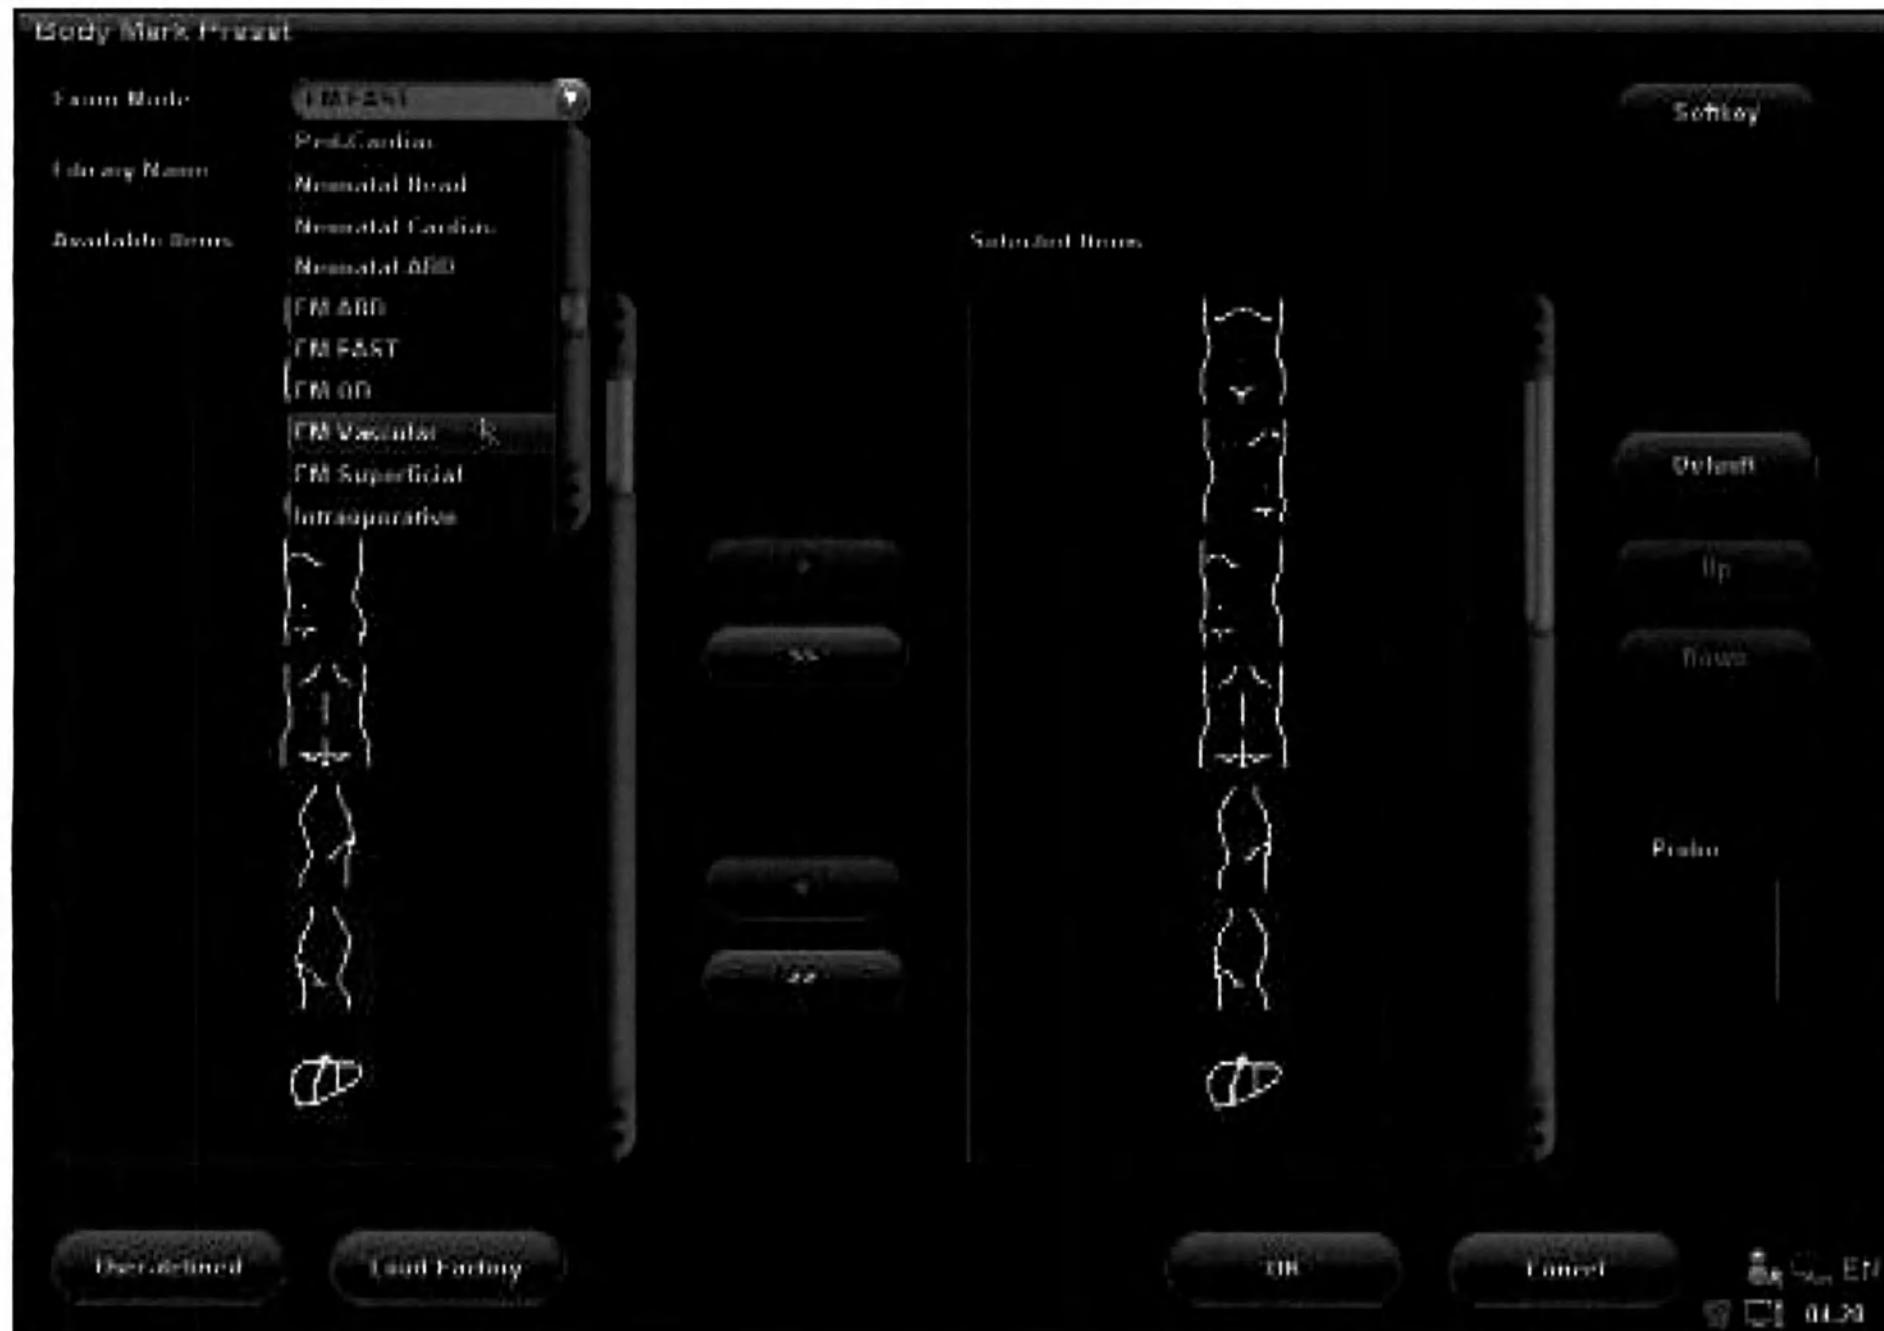

26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Storage		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Worklist

AE Title

Port

104

Maximum Retries

1

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Scheduled Station AE Title

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Worklist		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

03:36

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage Print Worklist **MPPS** StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device Service Name AE Title Port

Maximum Retries Interval Time(Sec) Timeout(Sec)

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 03:37

26.15. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device12

Service Name12-QueryRetrie

AE Title

Port104

Maximum Retries1

Interval Time(Sec)15

Timeout(Sec)15

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-QueryRetrieve		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate

35

SR Storage Option

Add

Cancel

Not Store SR

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List

	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

26.17. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR)

DICOM Service

Storage | Print | Worklist | MPPS | StorageCommitment | Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel

Service List

	Device		Default
1	12	12-Storage	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
☒ Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option

Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements
Not Store SR
12-Storage

Add
Cancel

Service List

	Device		Default
1	12	12-Storage	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33


26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)




26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)




26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)

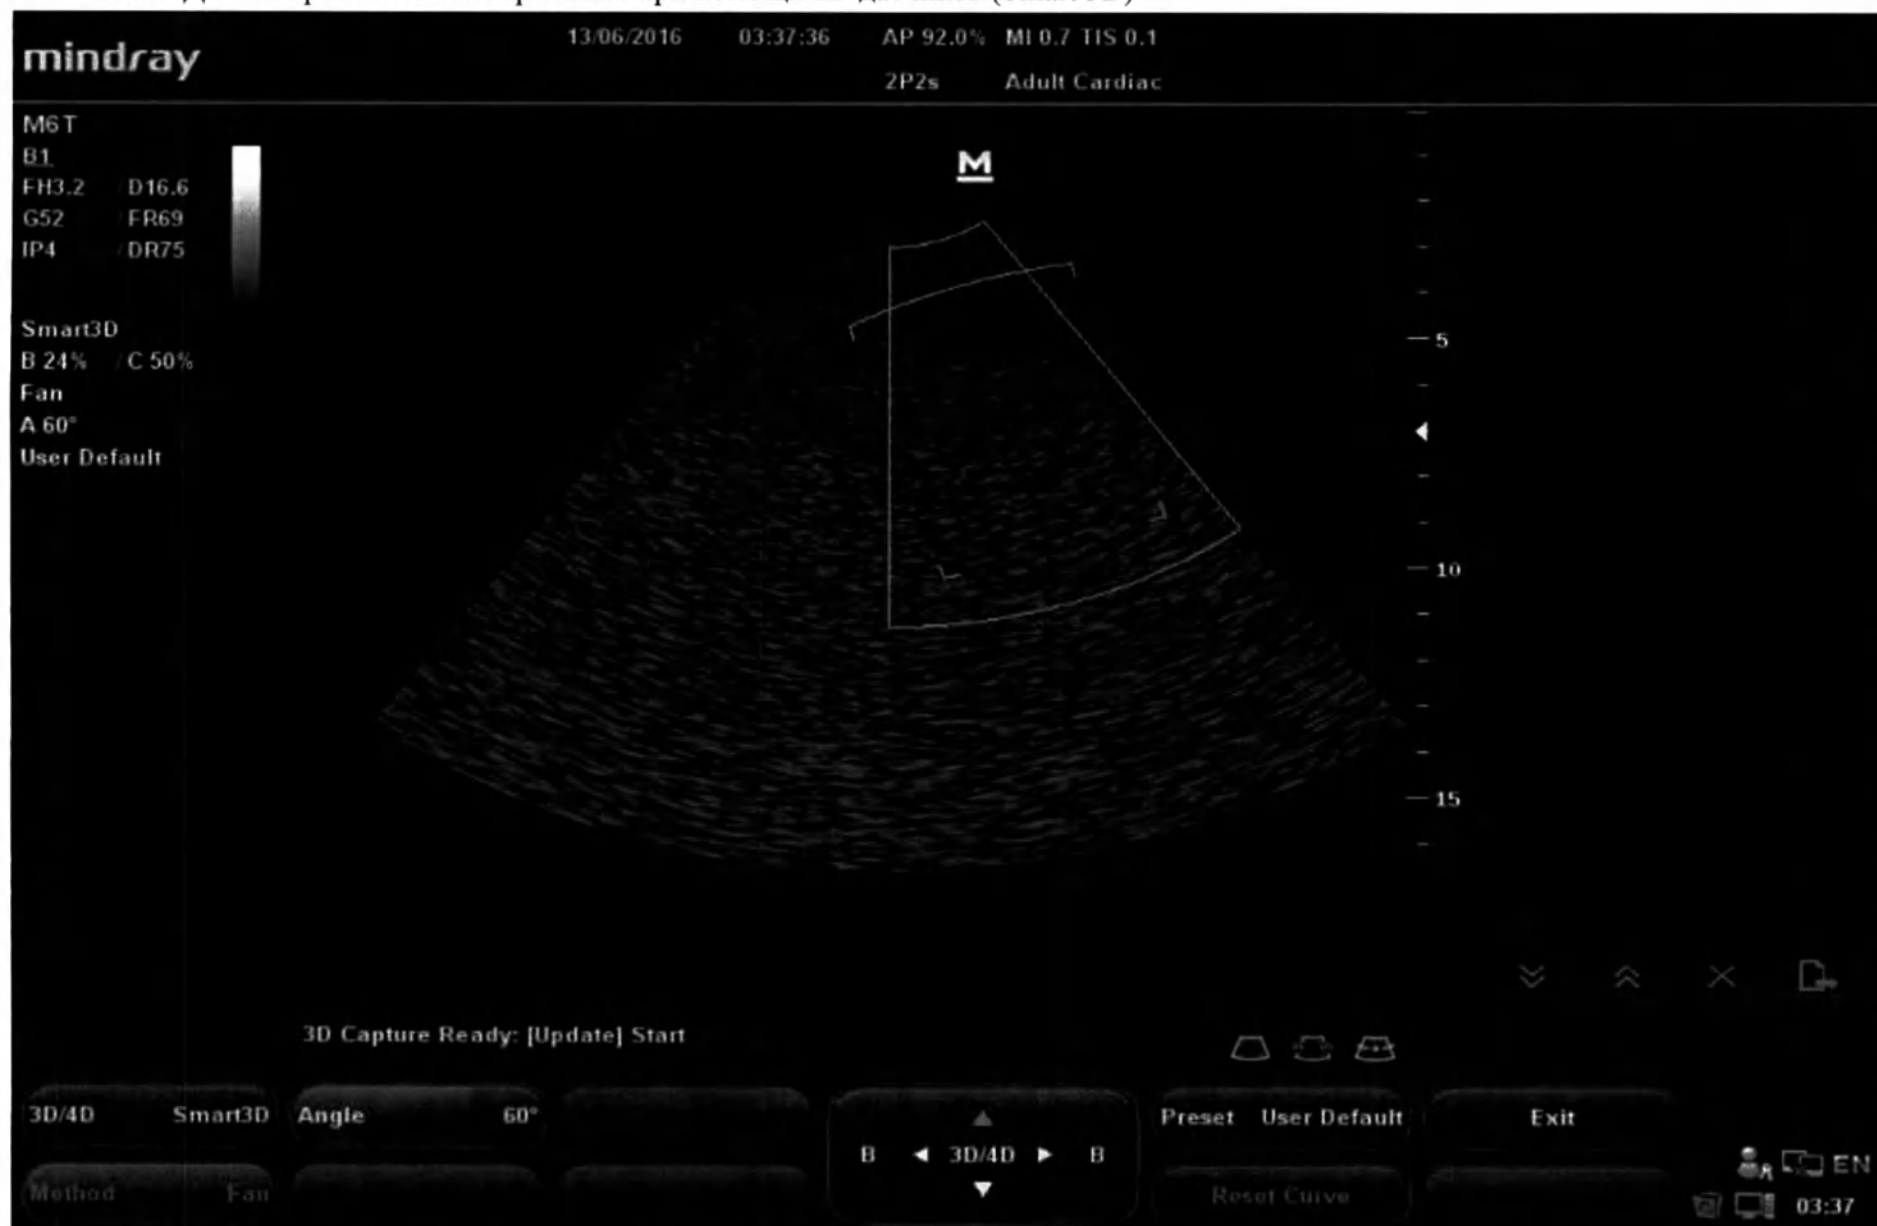

26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)

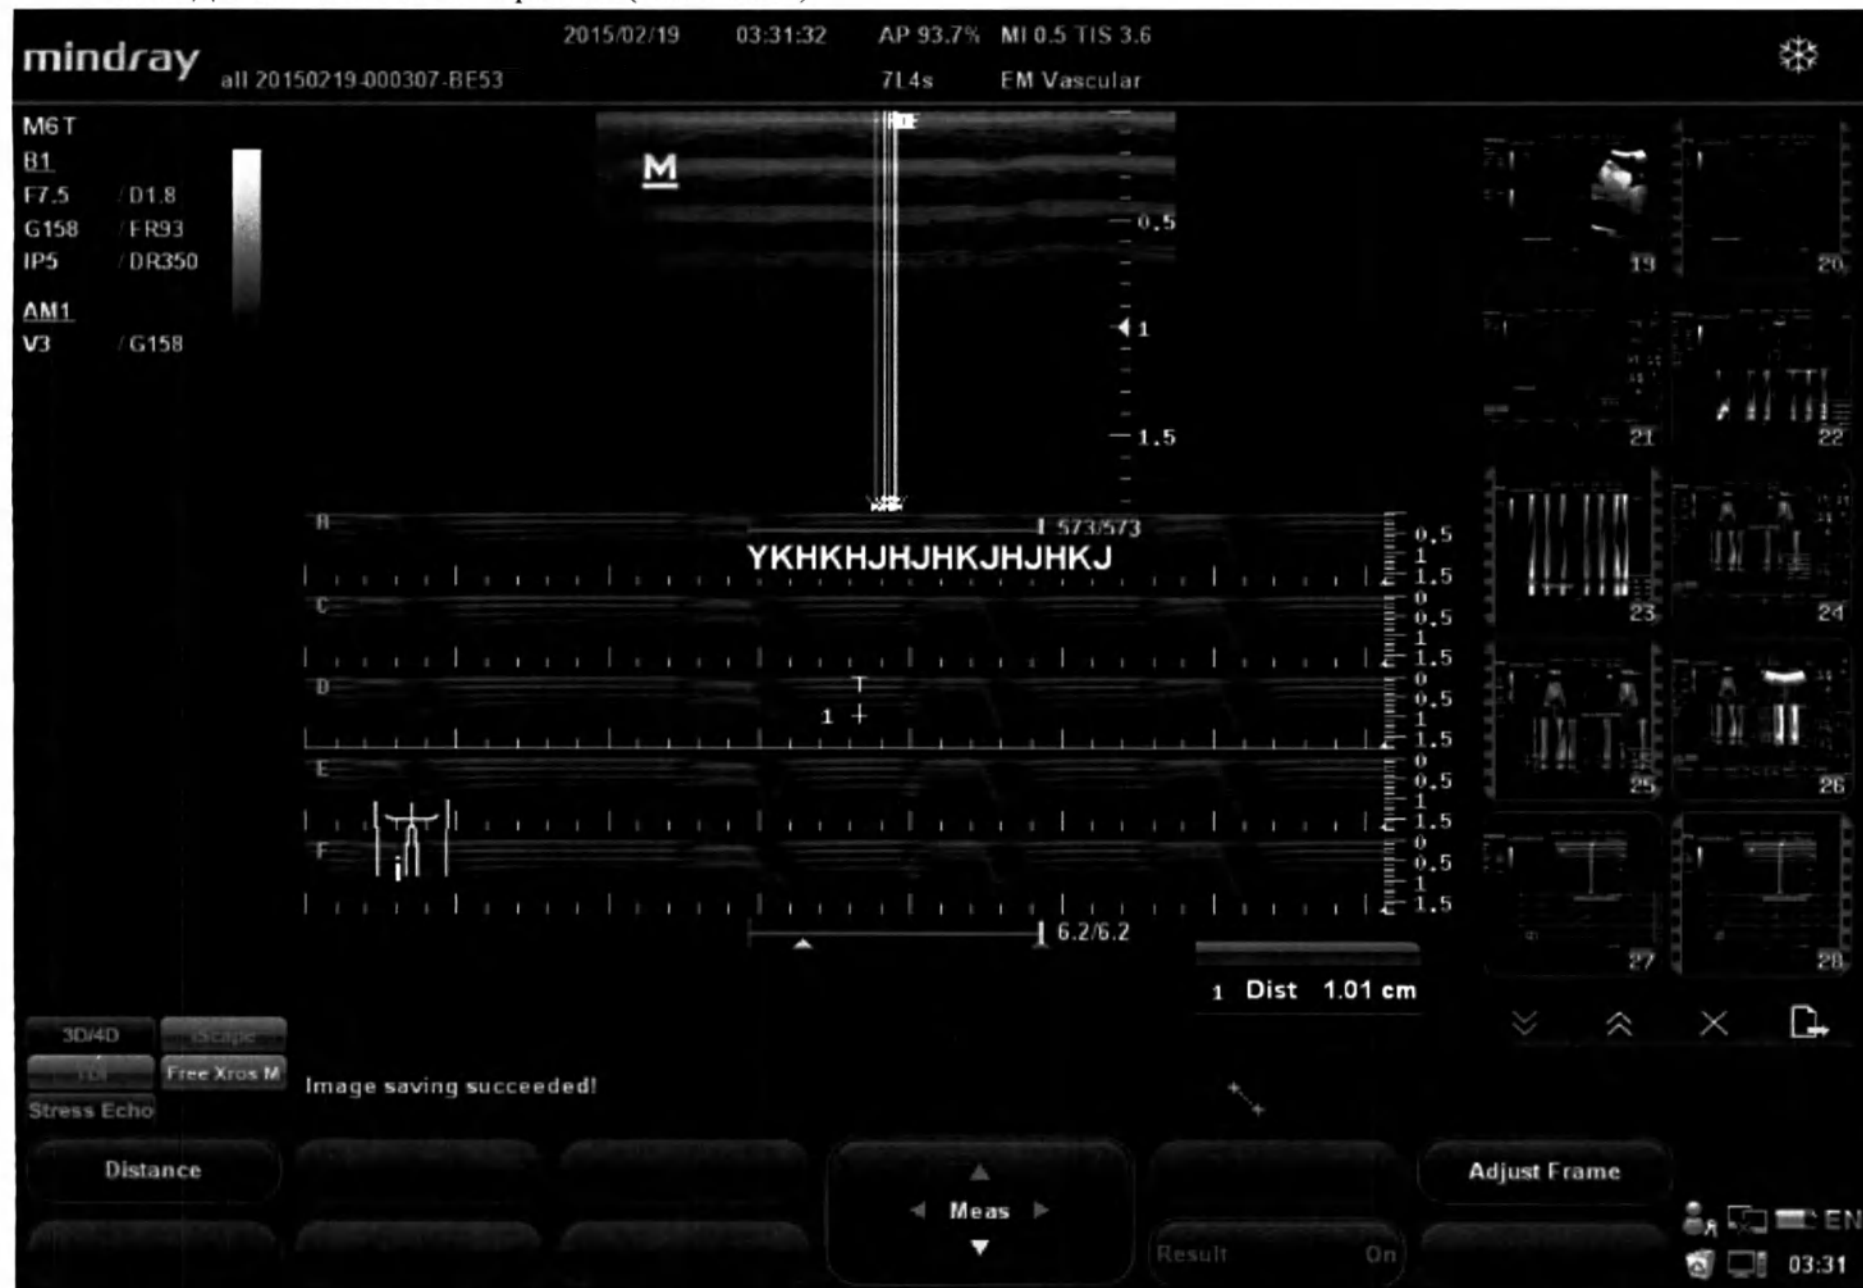

26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)

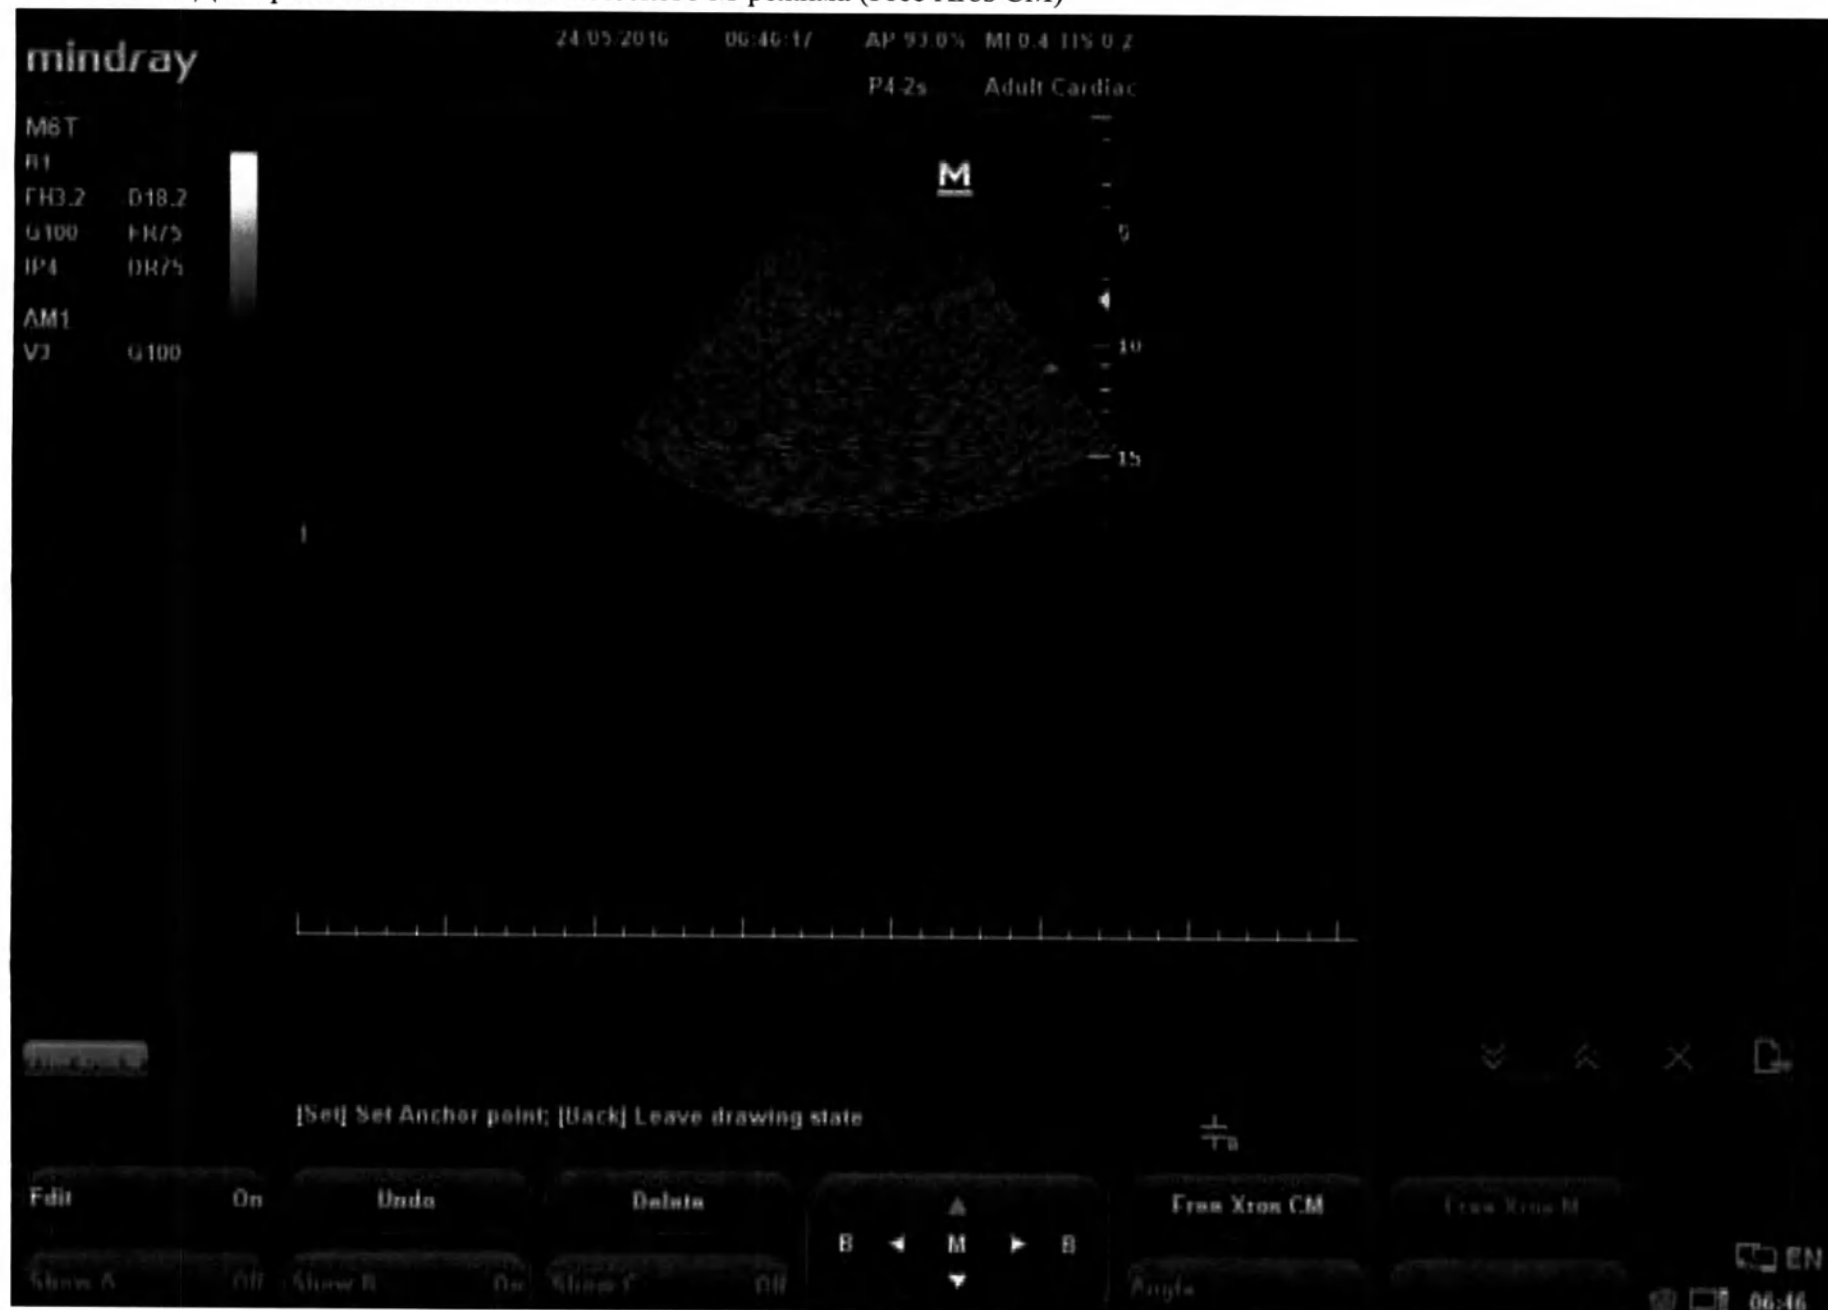

26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)



26.25. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)





26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)



26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)




26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)







26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

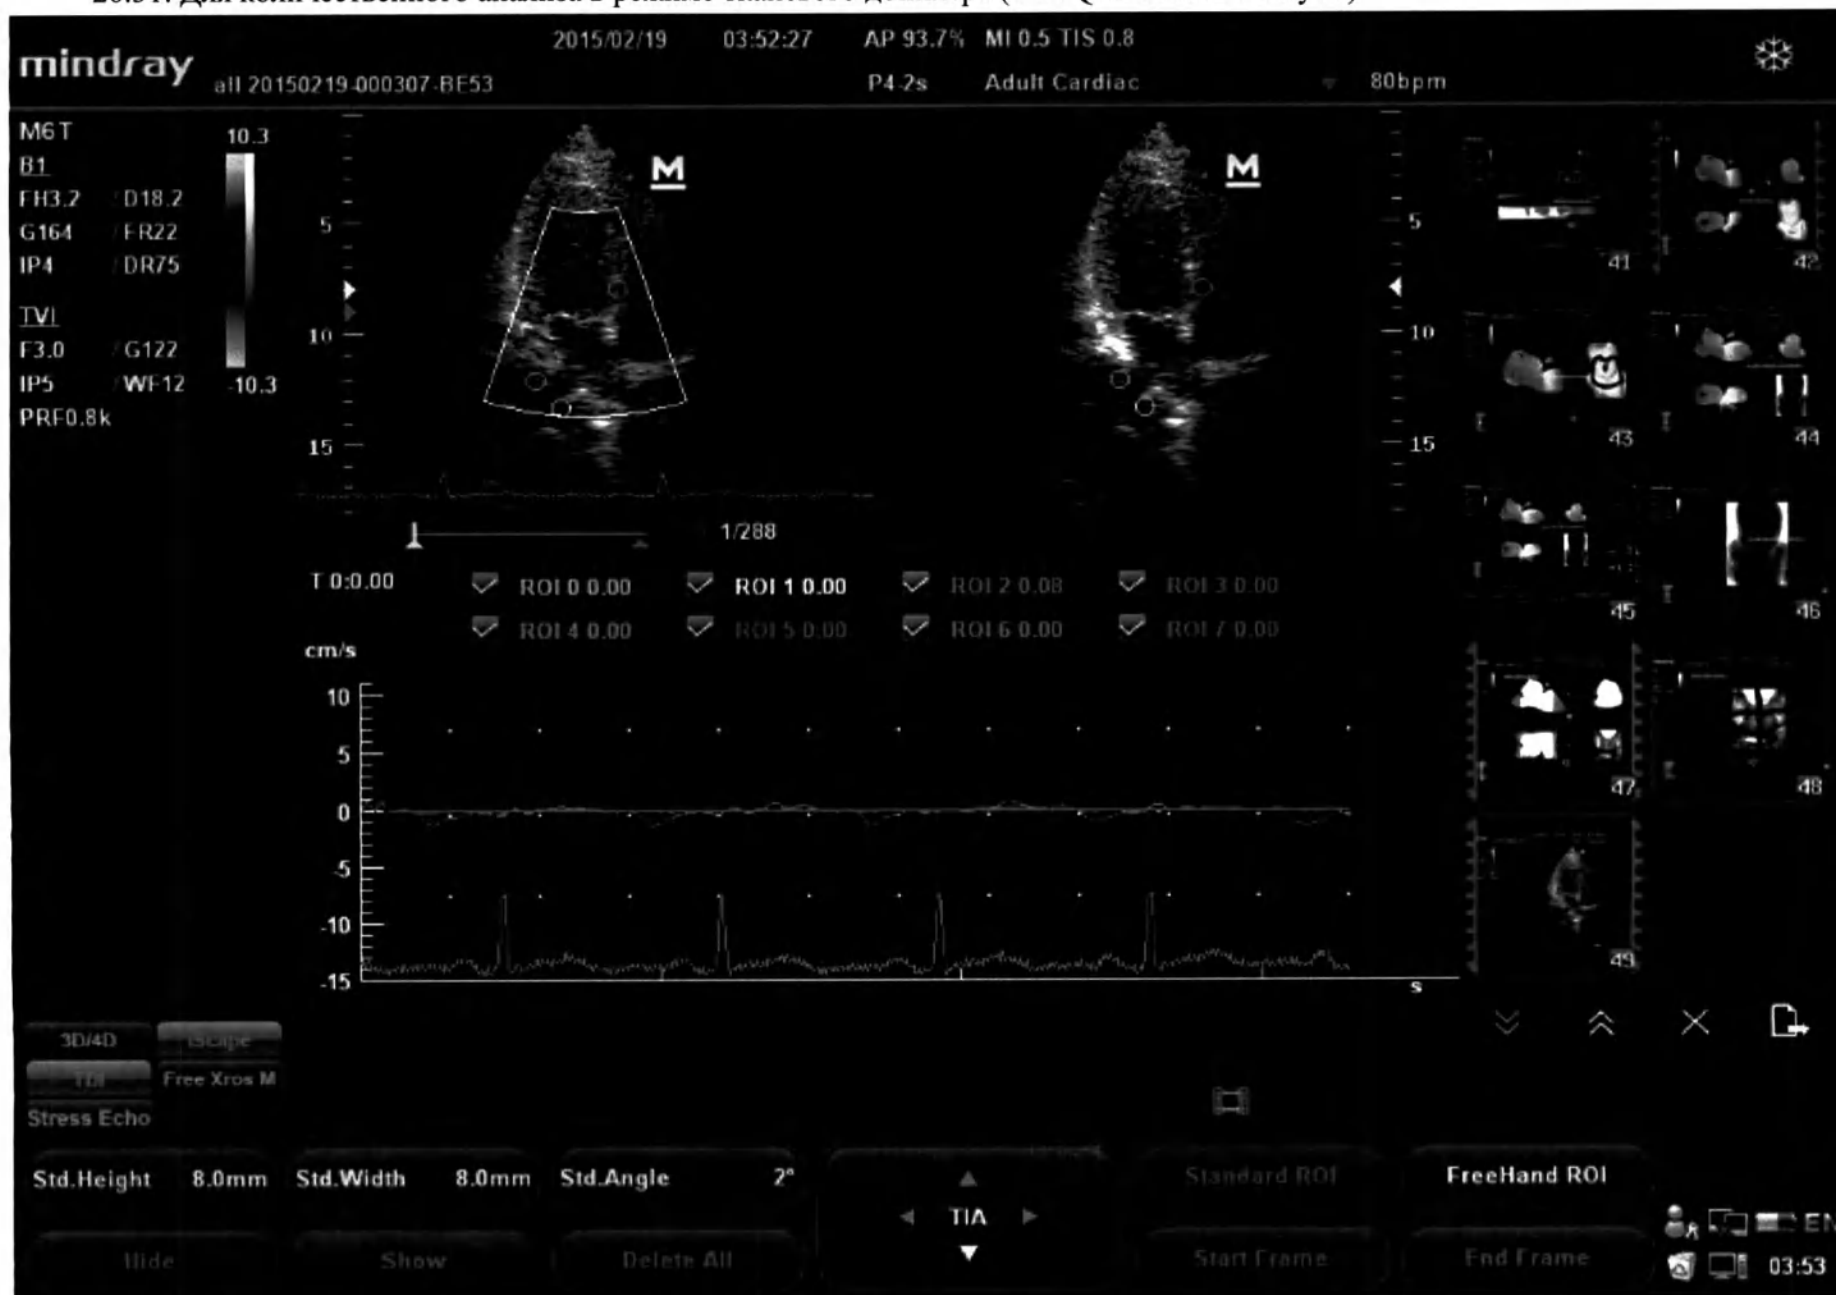


27.Модули:


27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

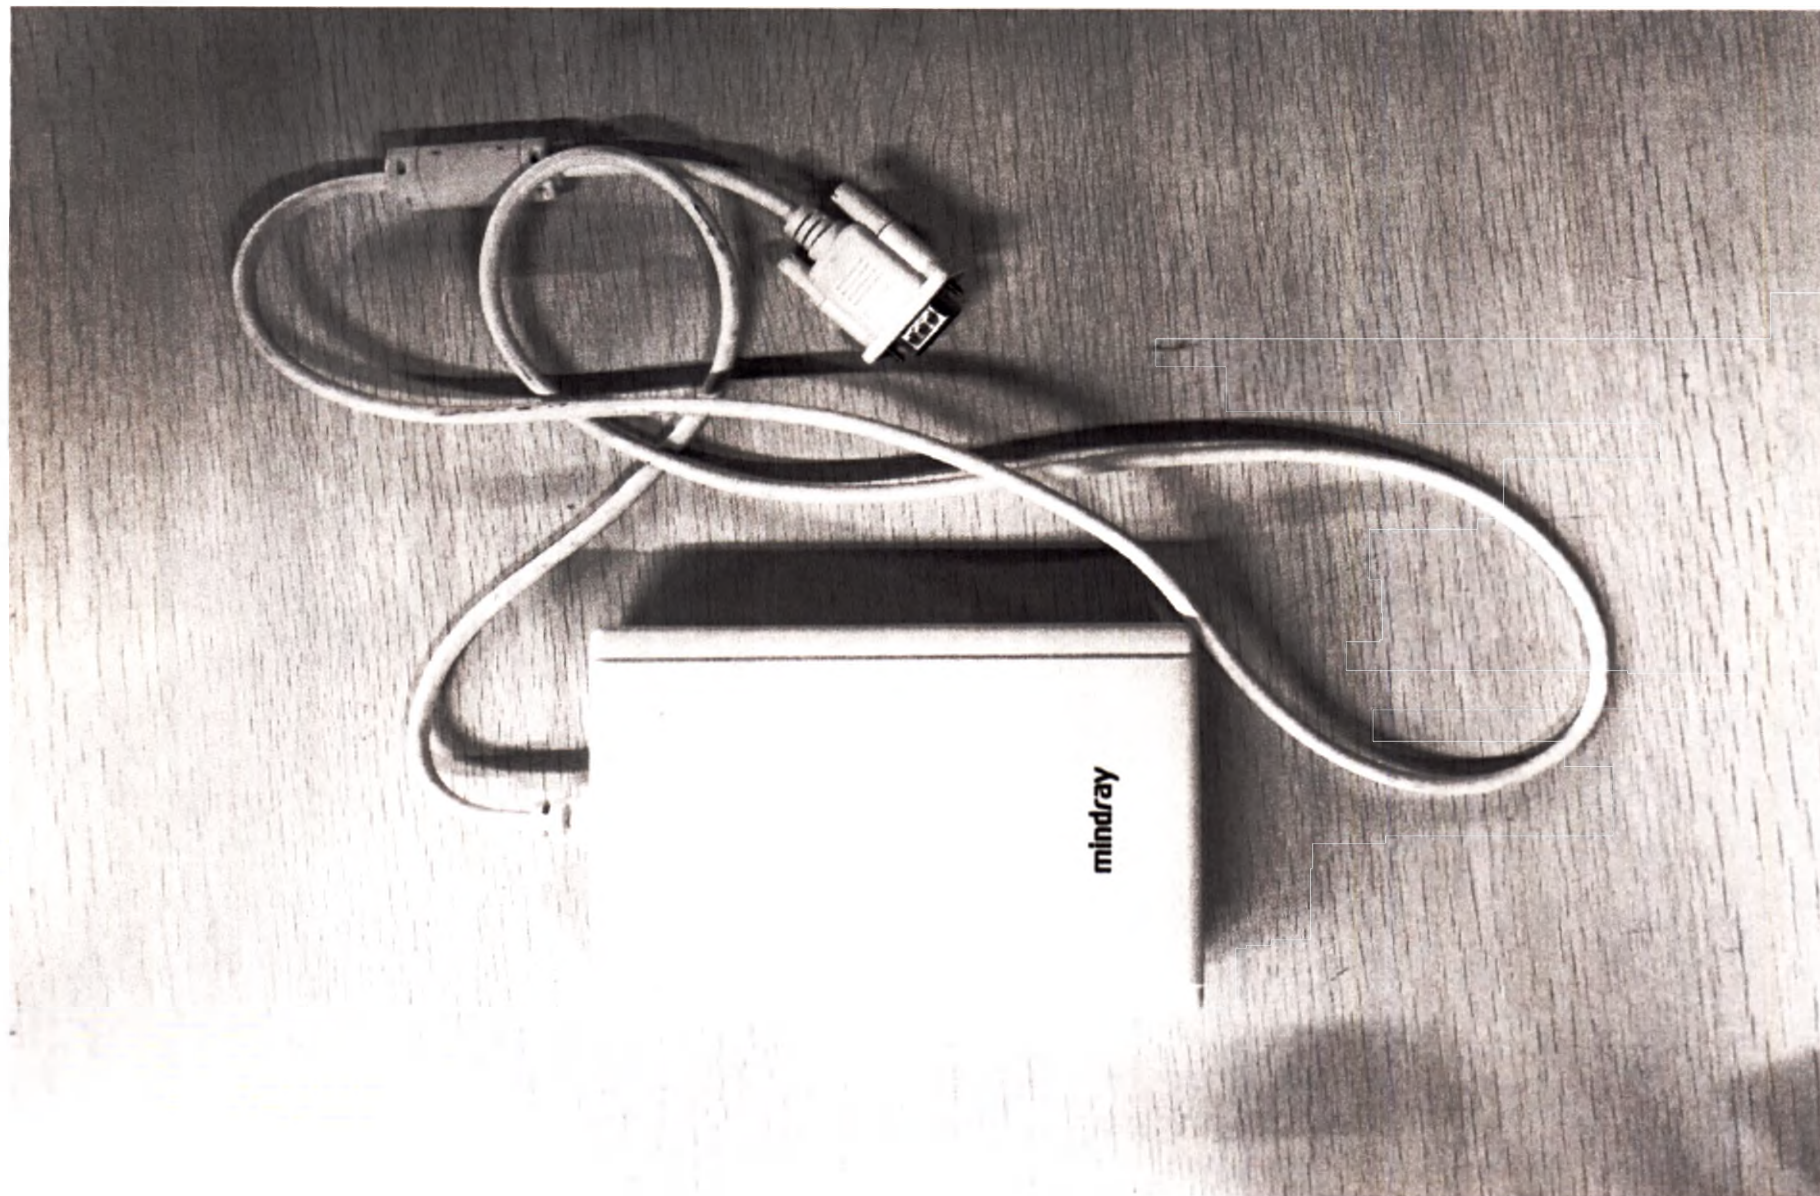

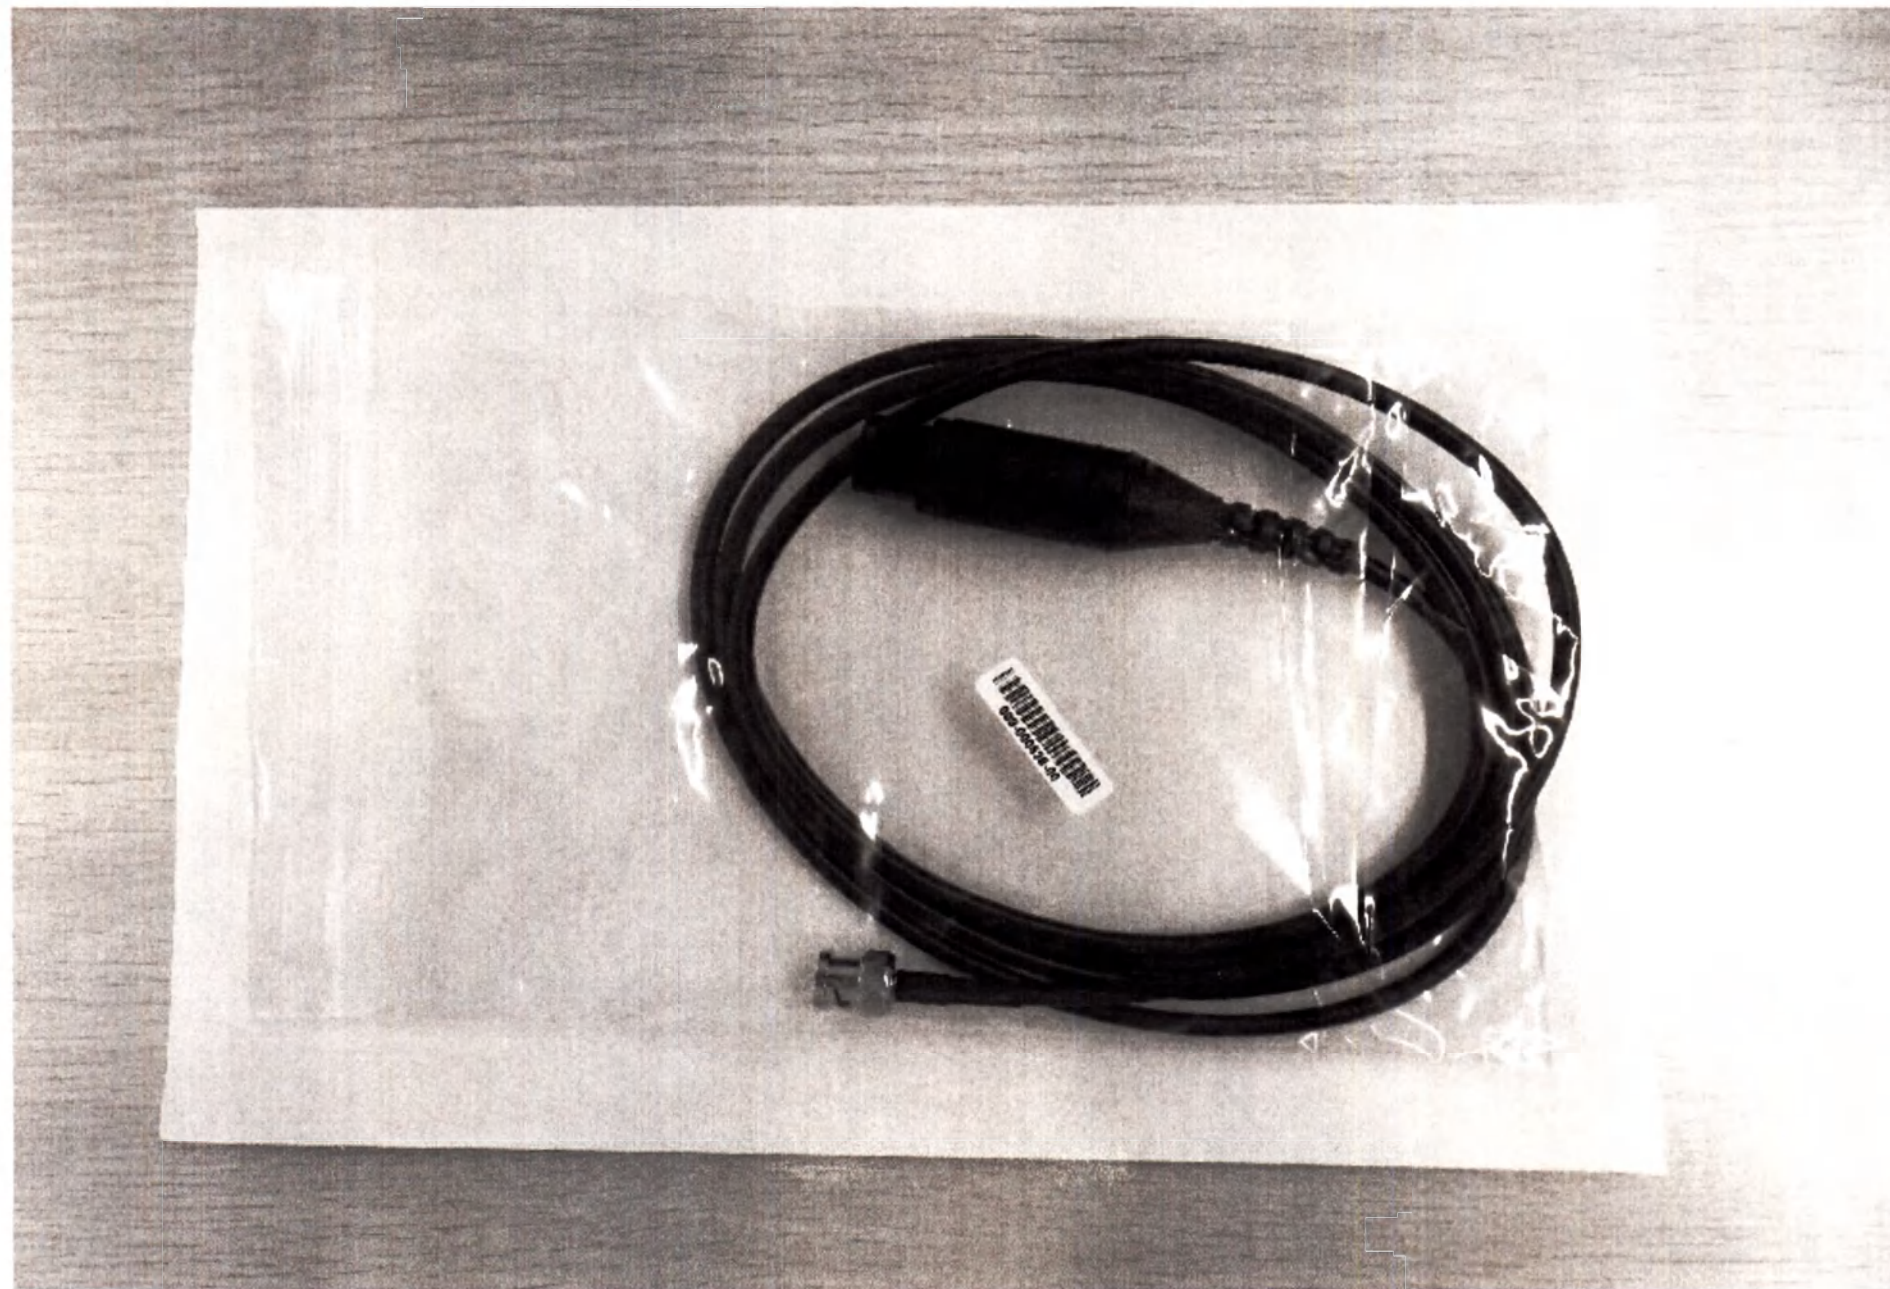




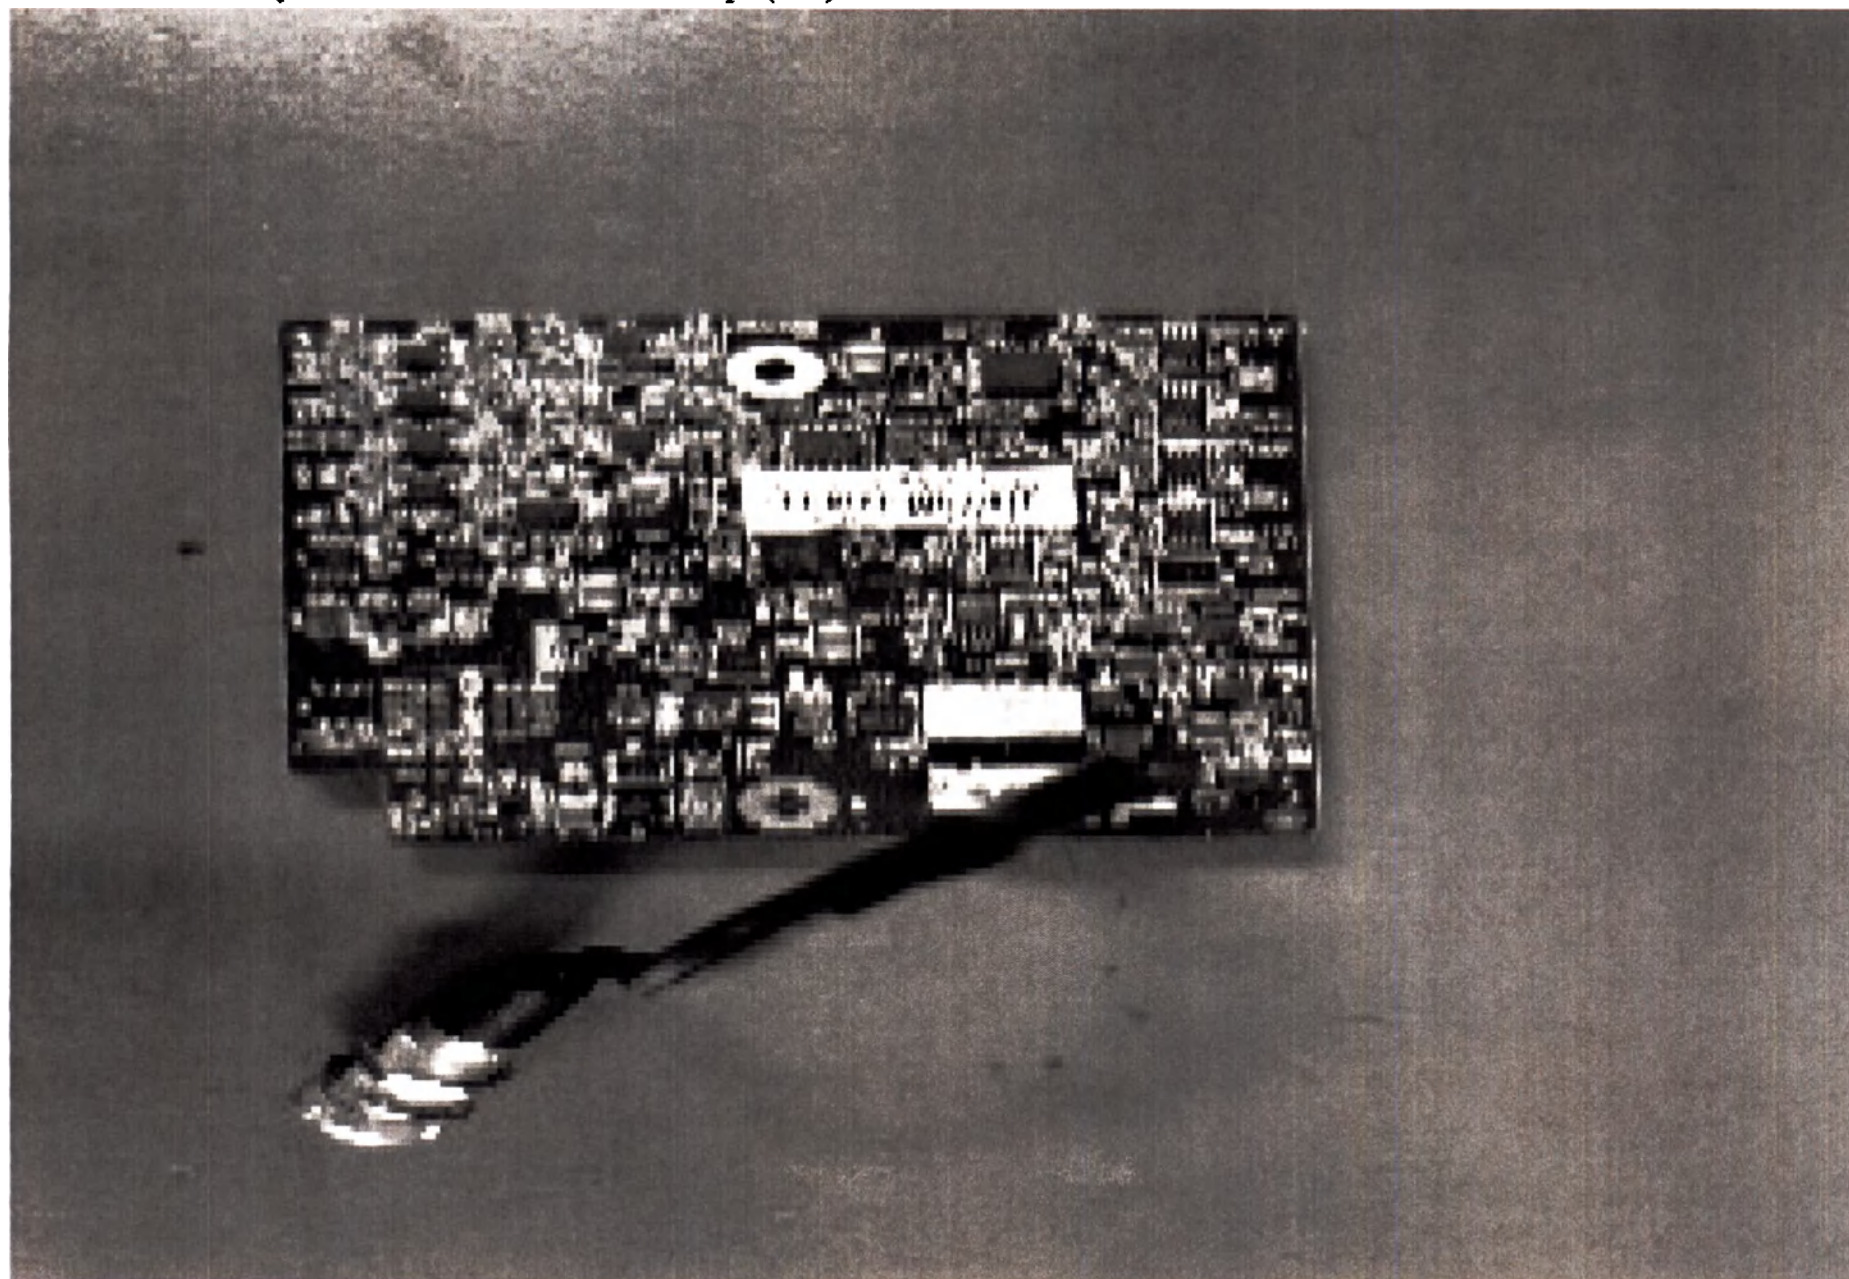


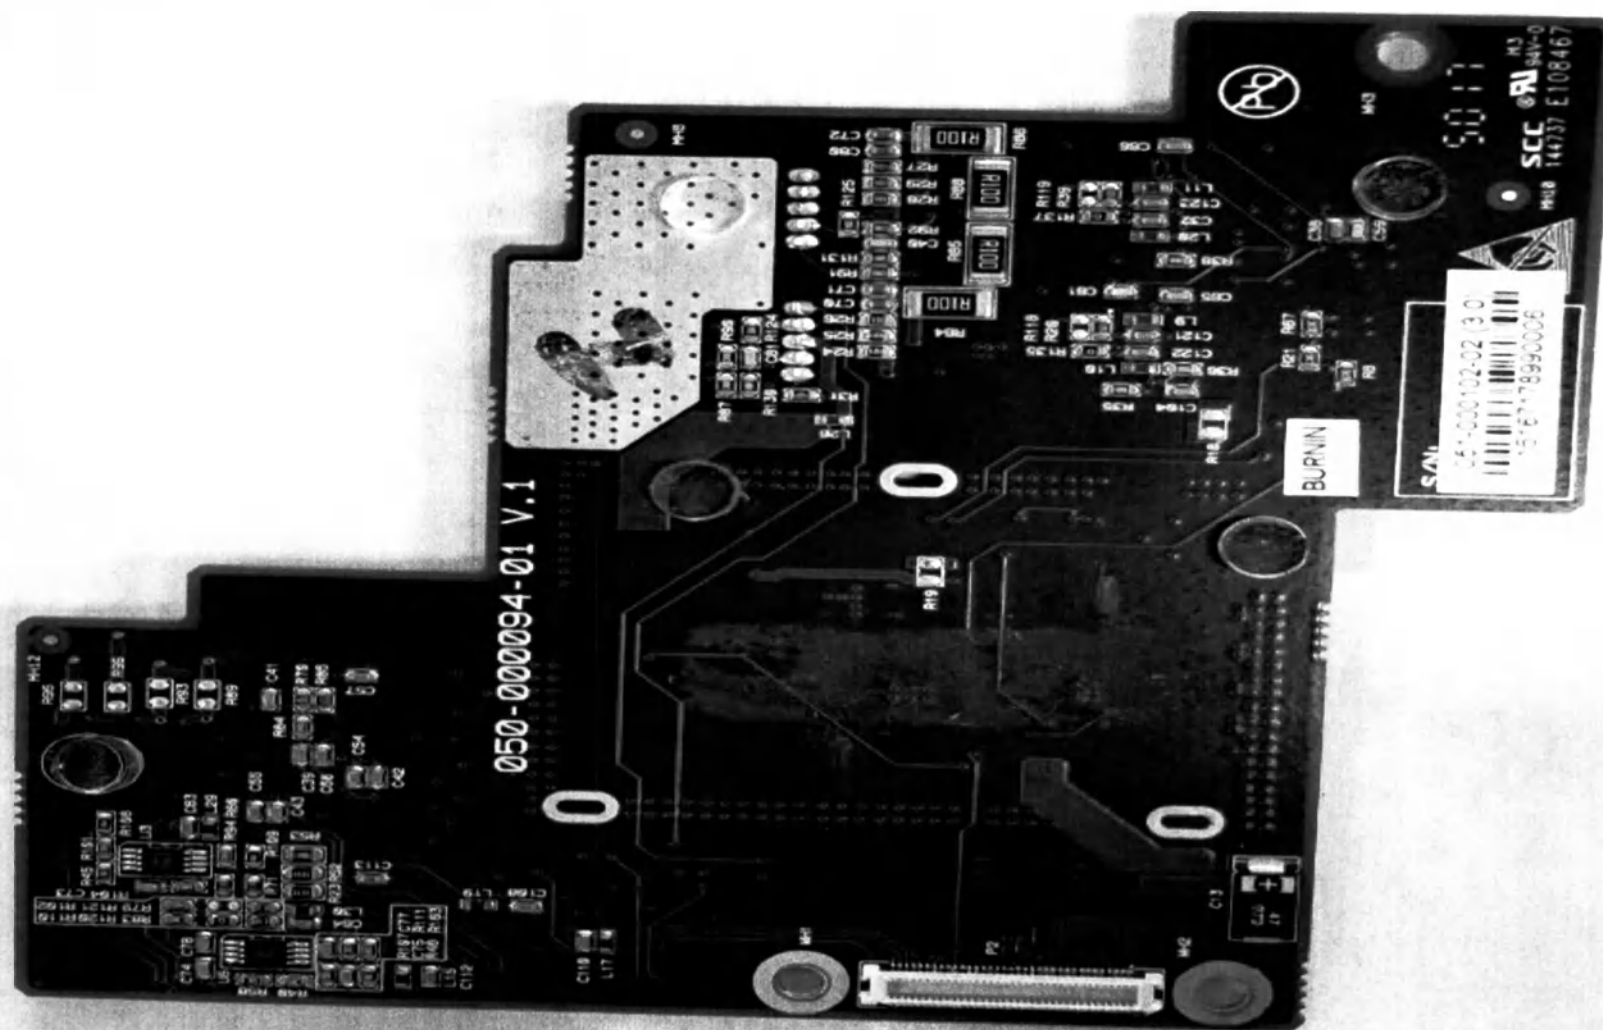



28. Тележки

28. 1 . Тележка мобильная UMT - 300

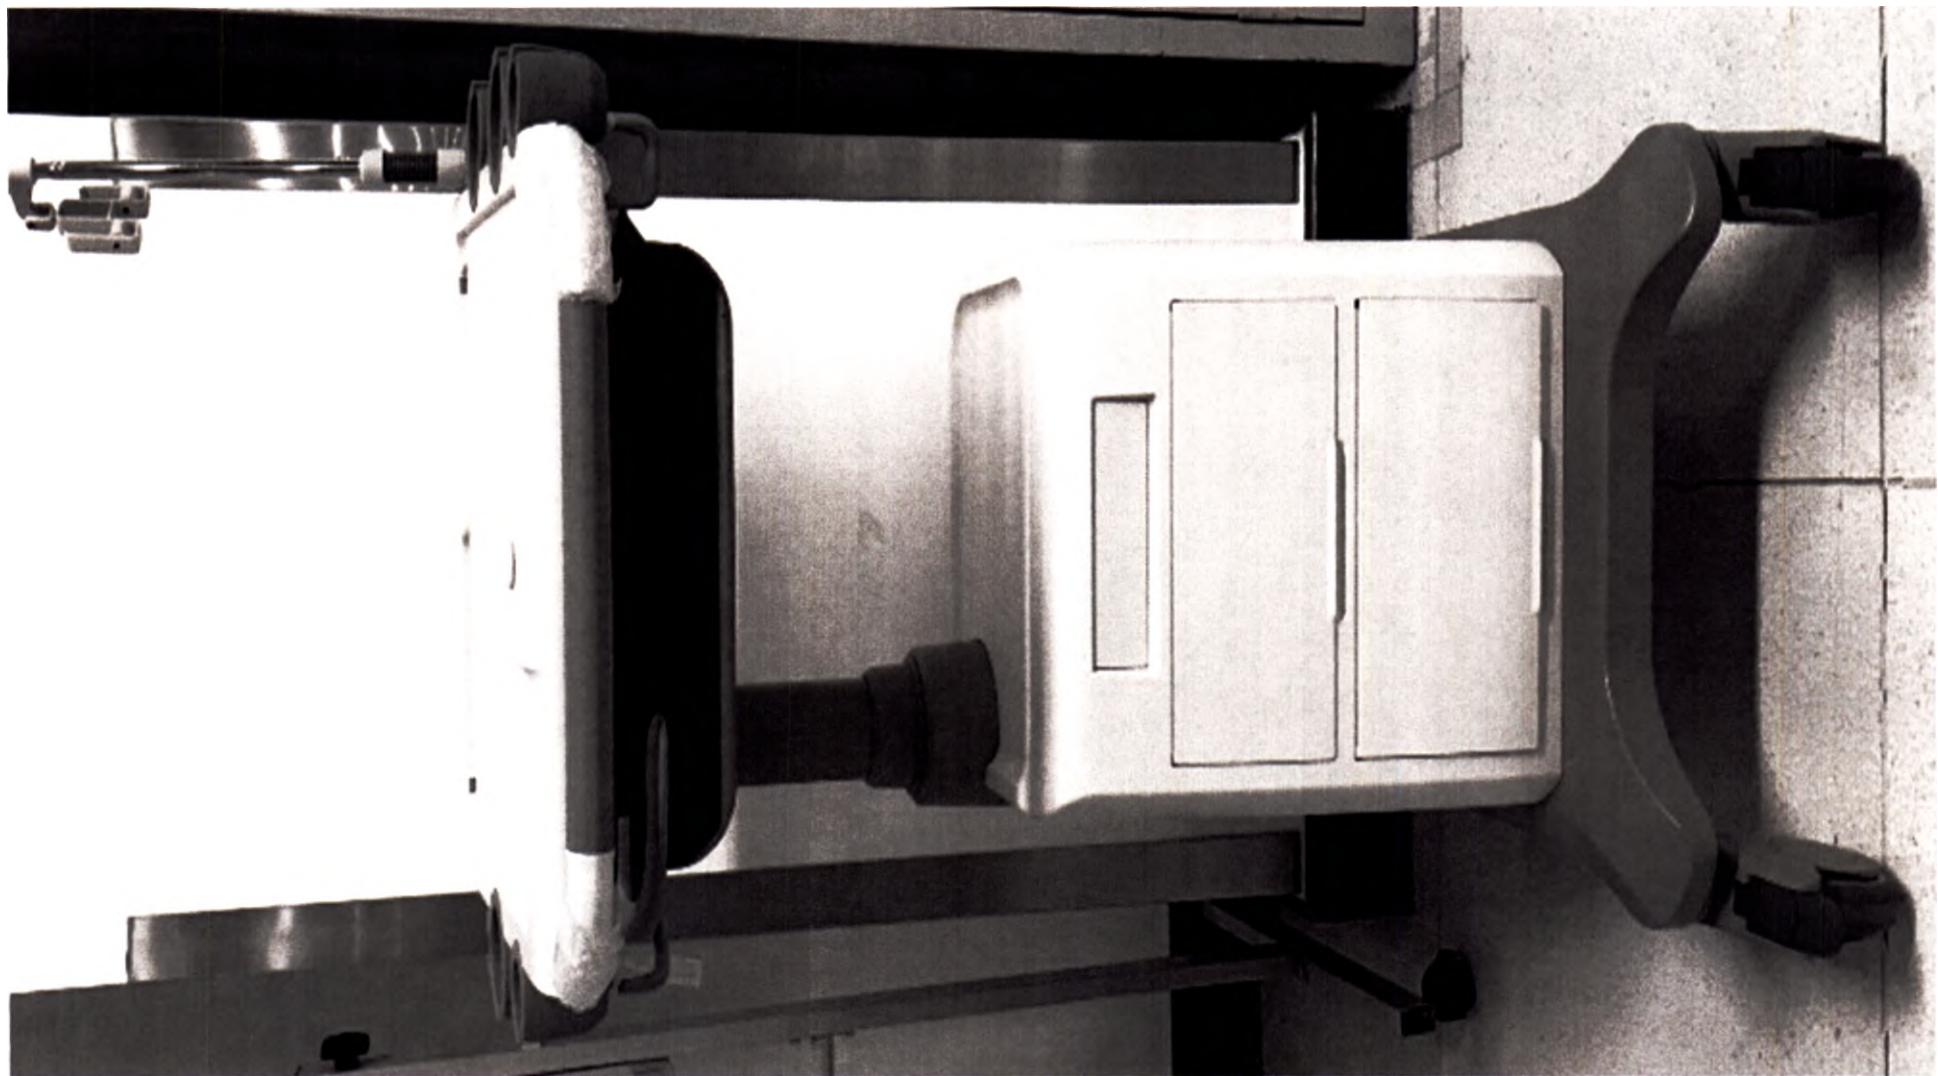

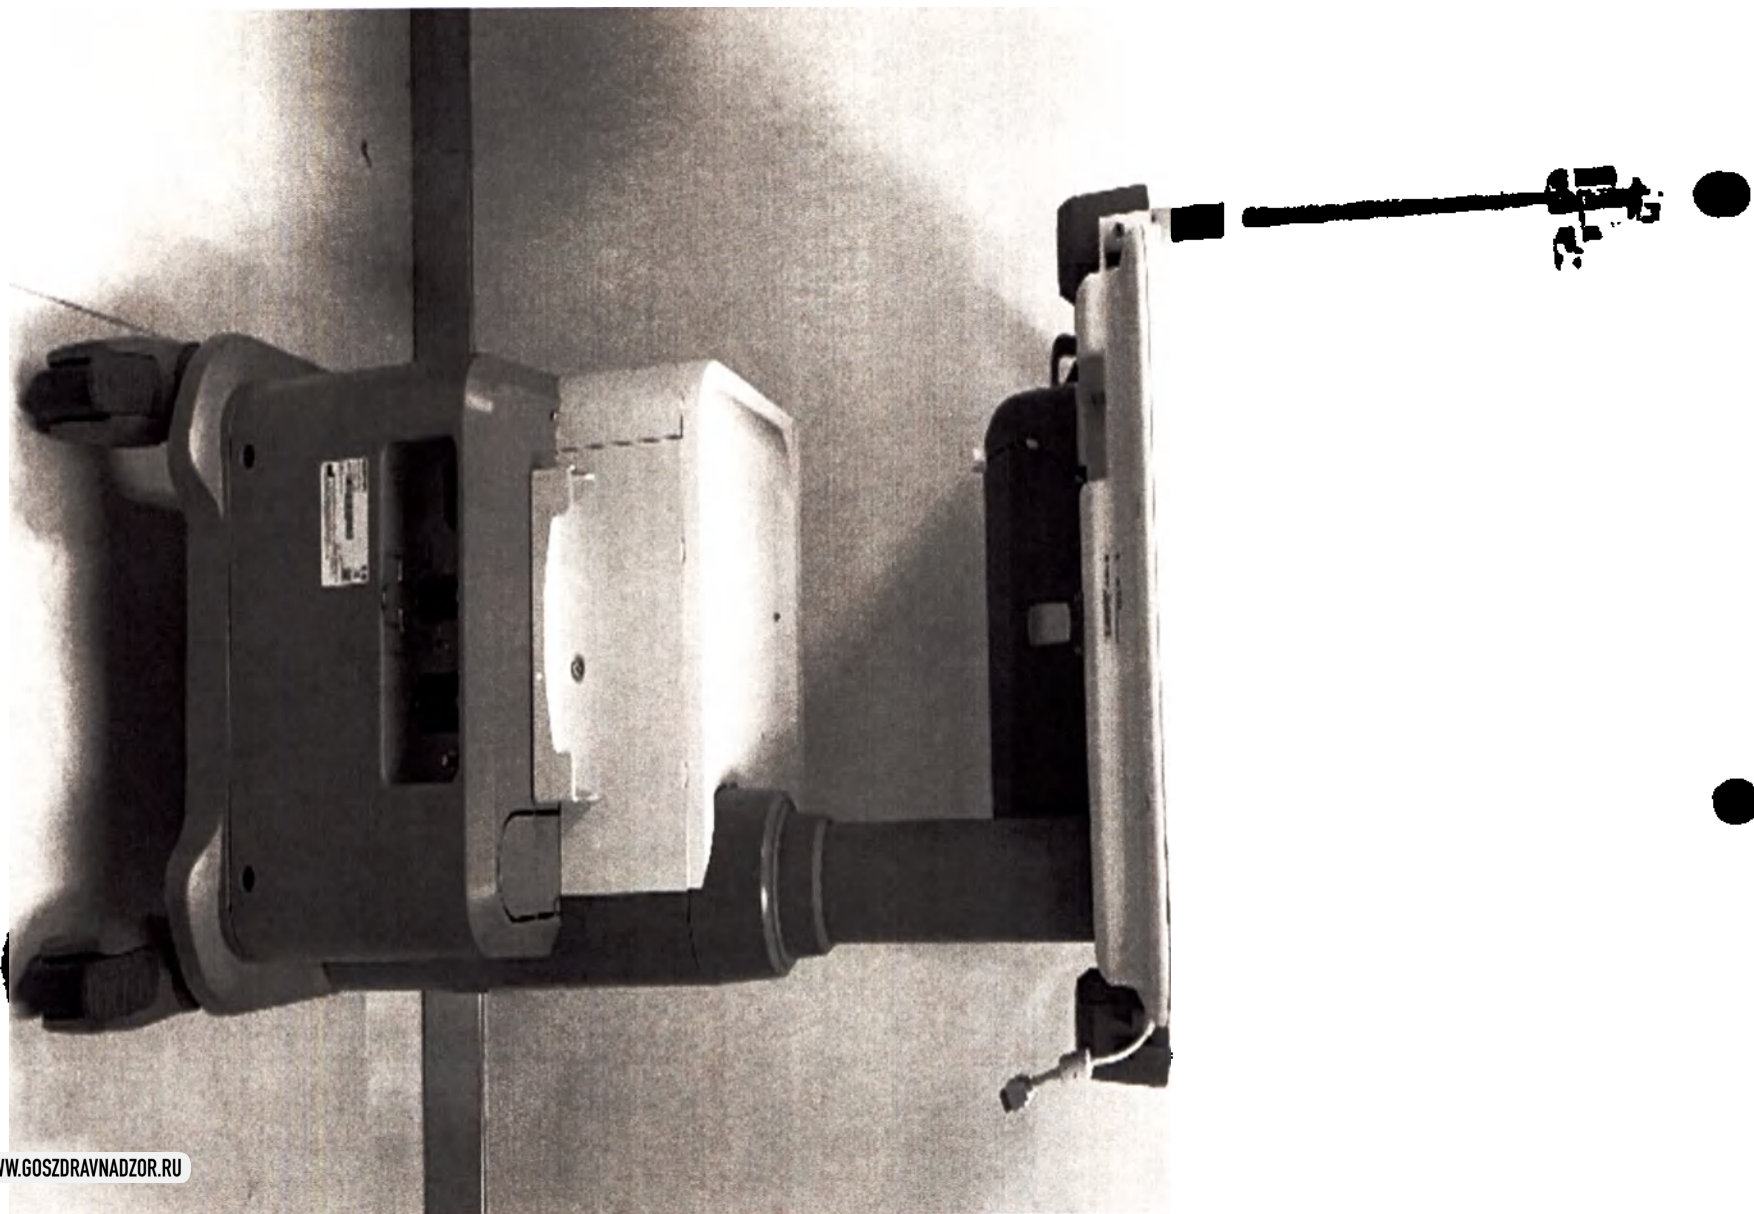


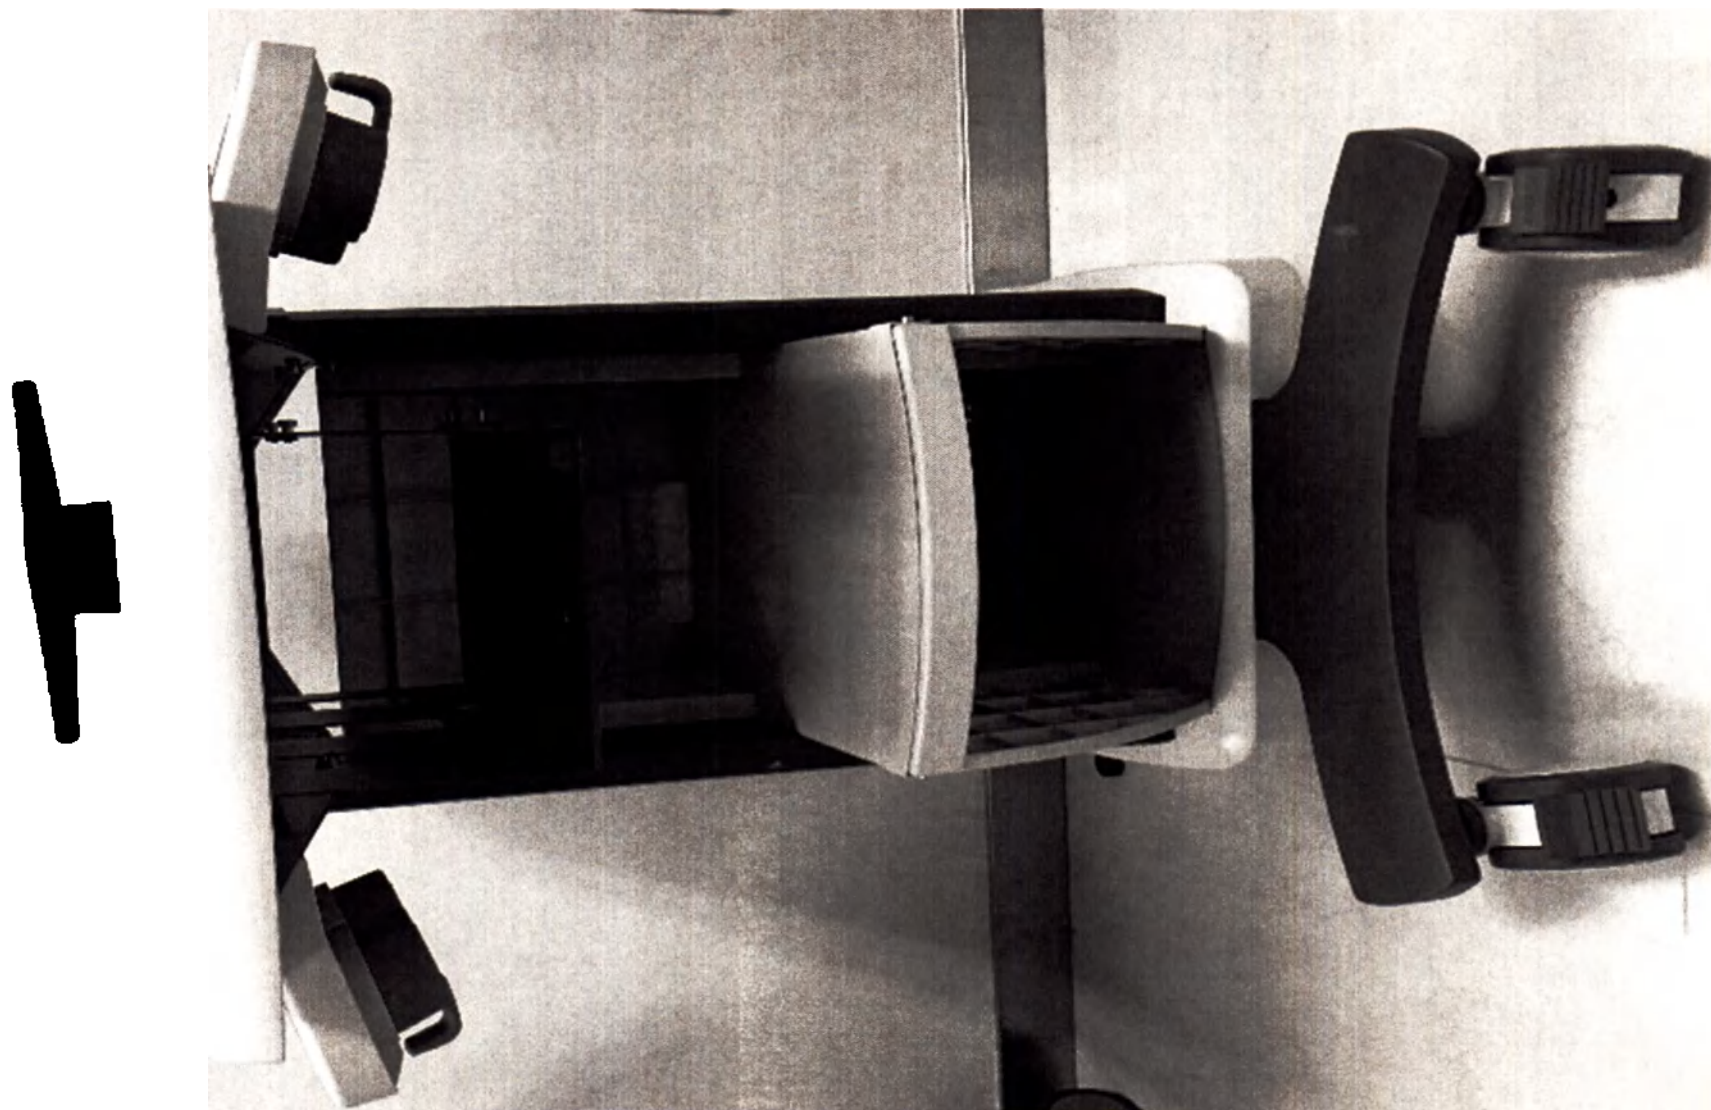

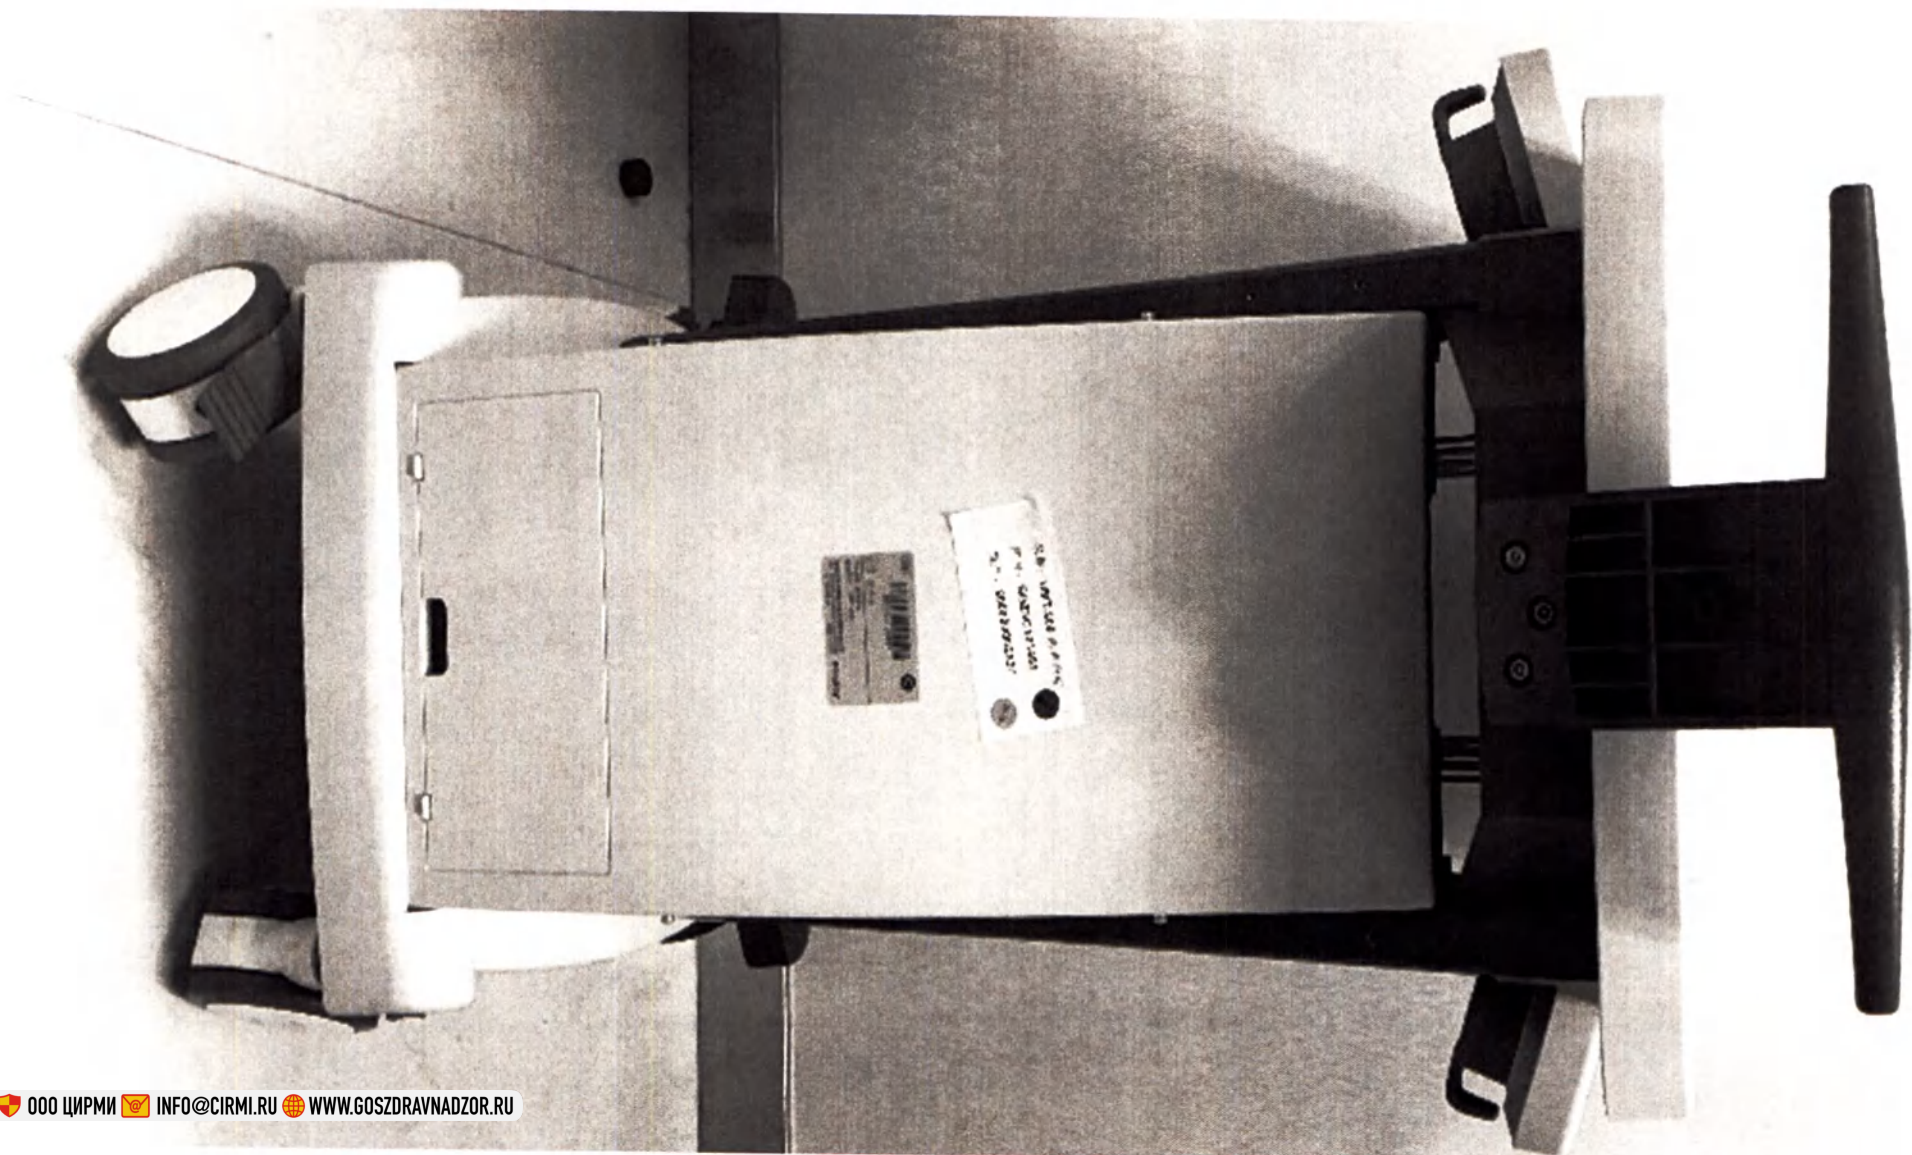

Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши

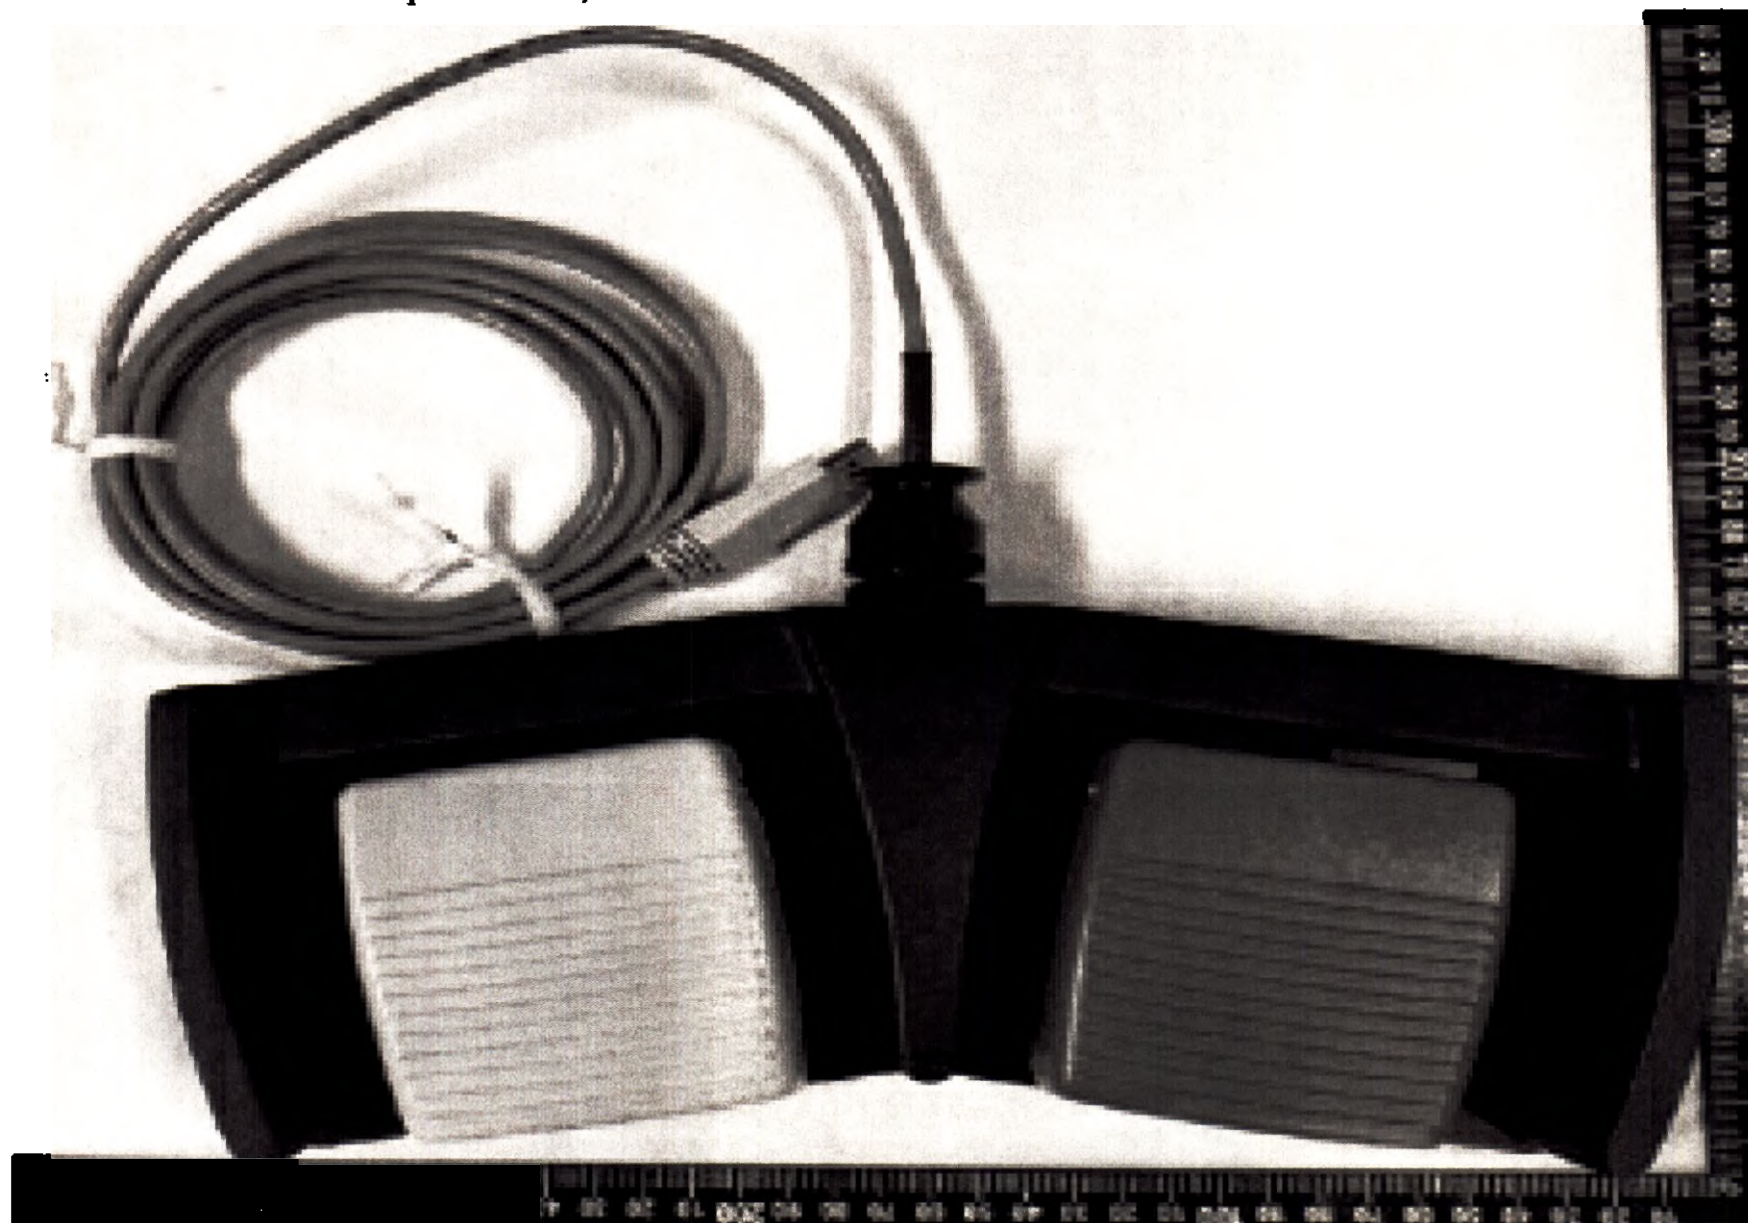



2.Ножной переключатель, 3 клавиши



IV. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М6 Экспресс, в составе:


1. Основной блок М6 Экспресс

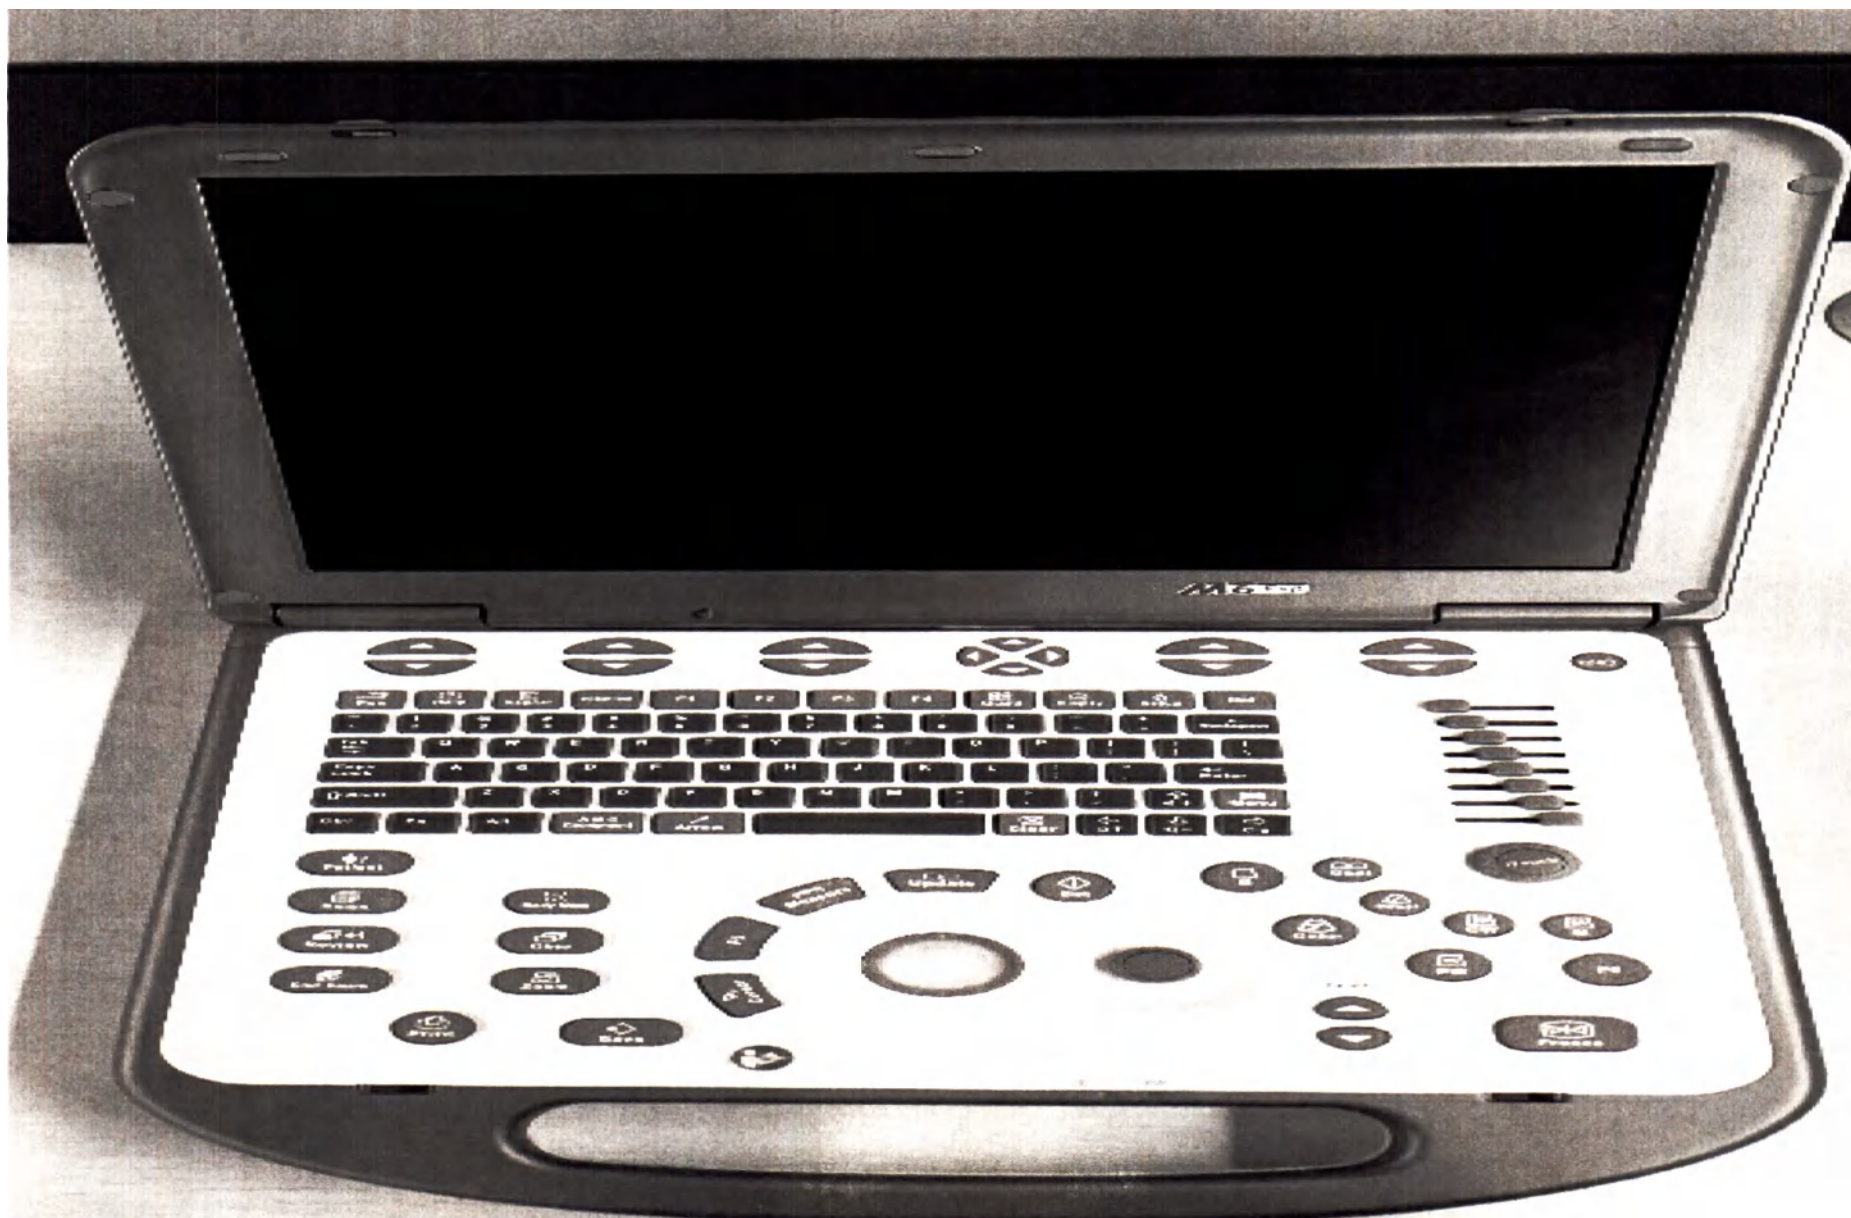


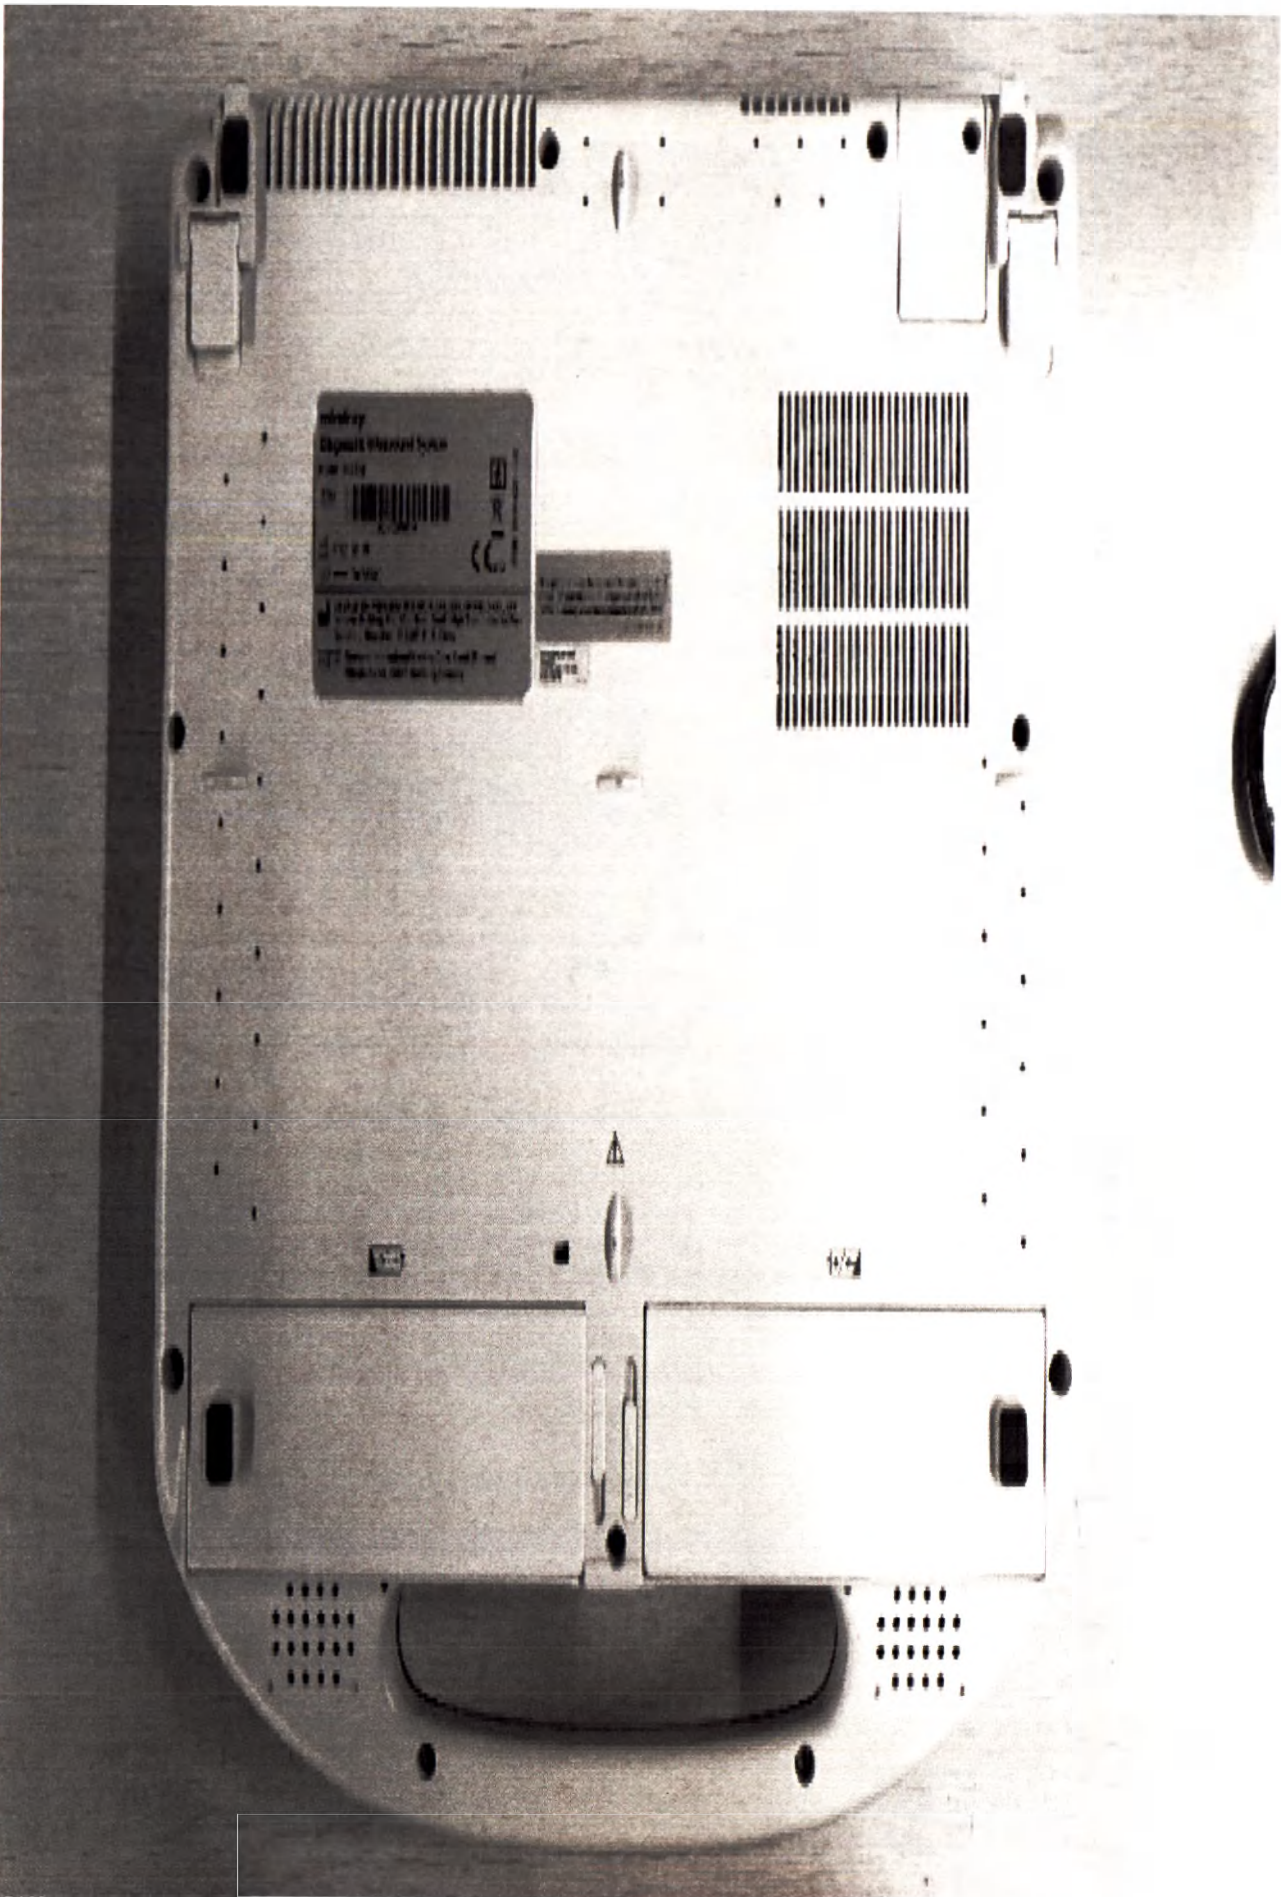



4. Кабель питания

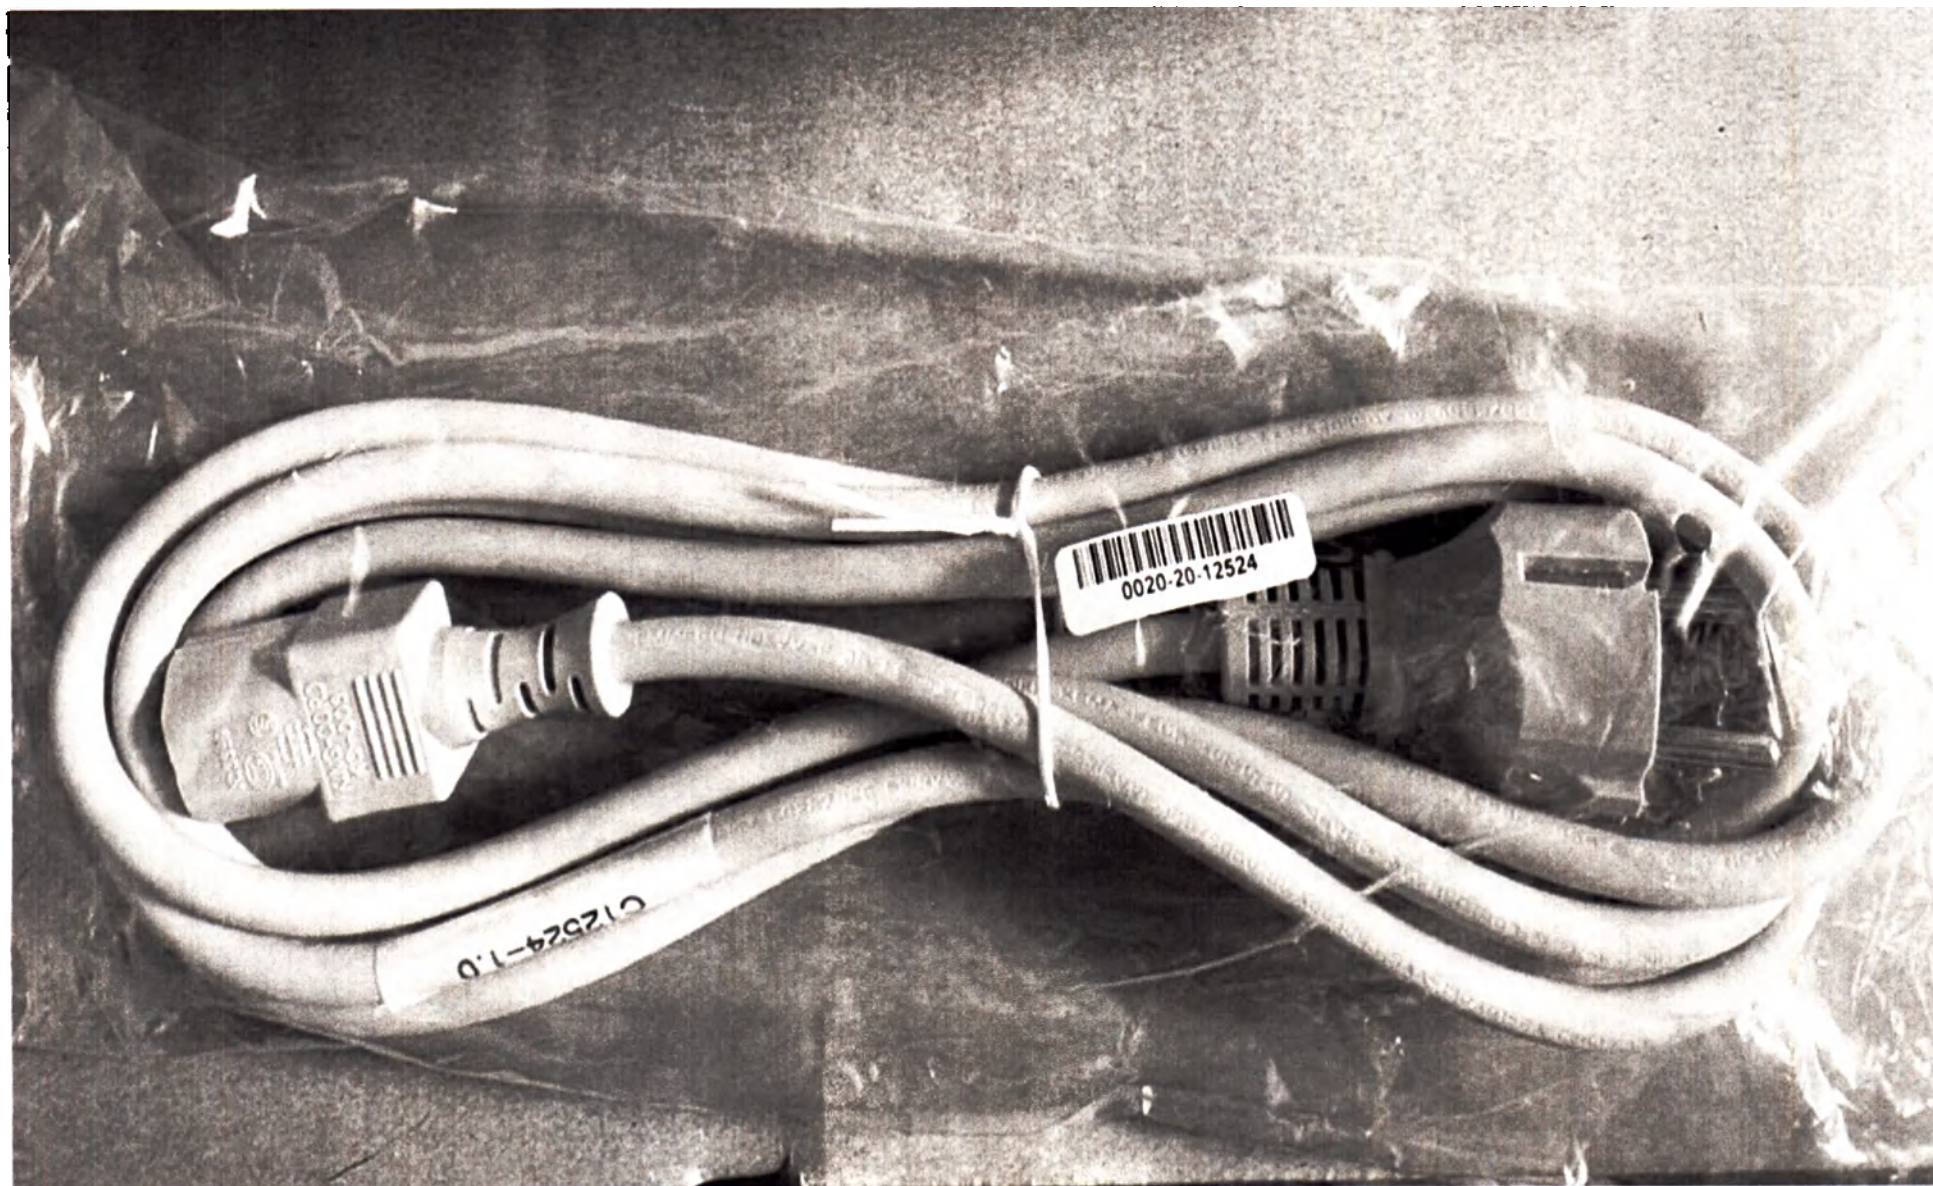

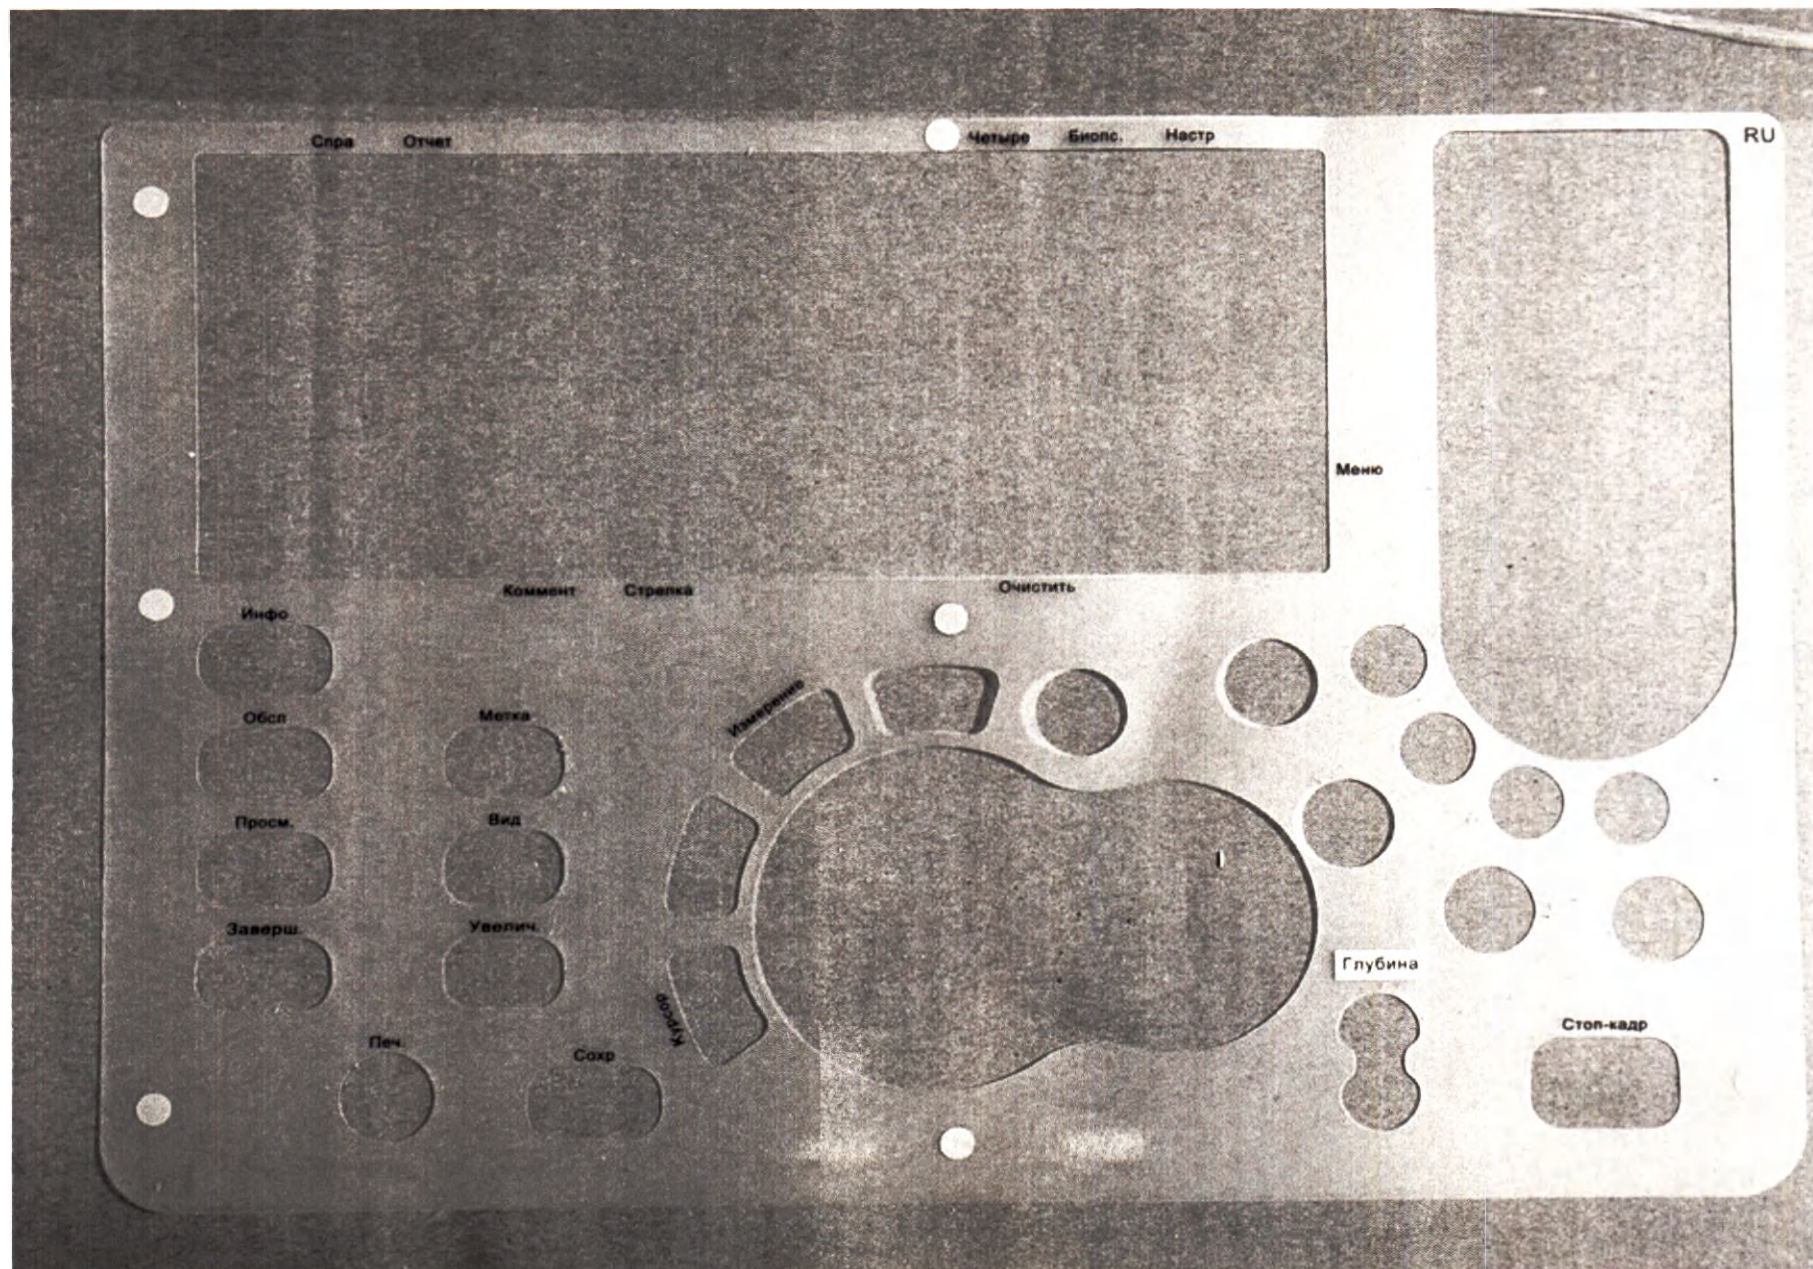


6. Адаптер питания







8. Разветвитель для датчиков

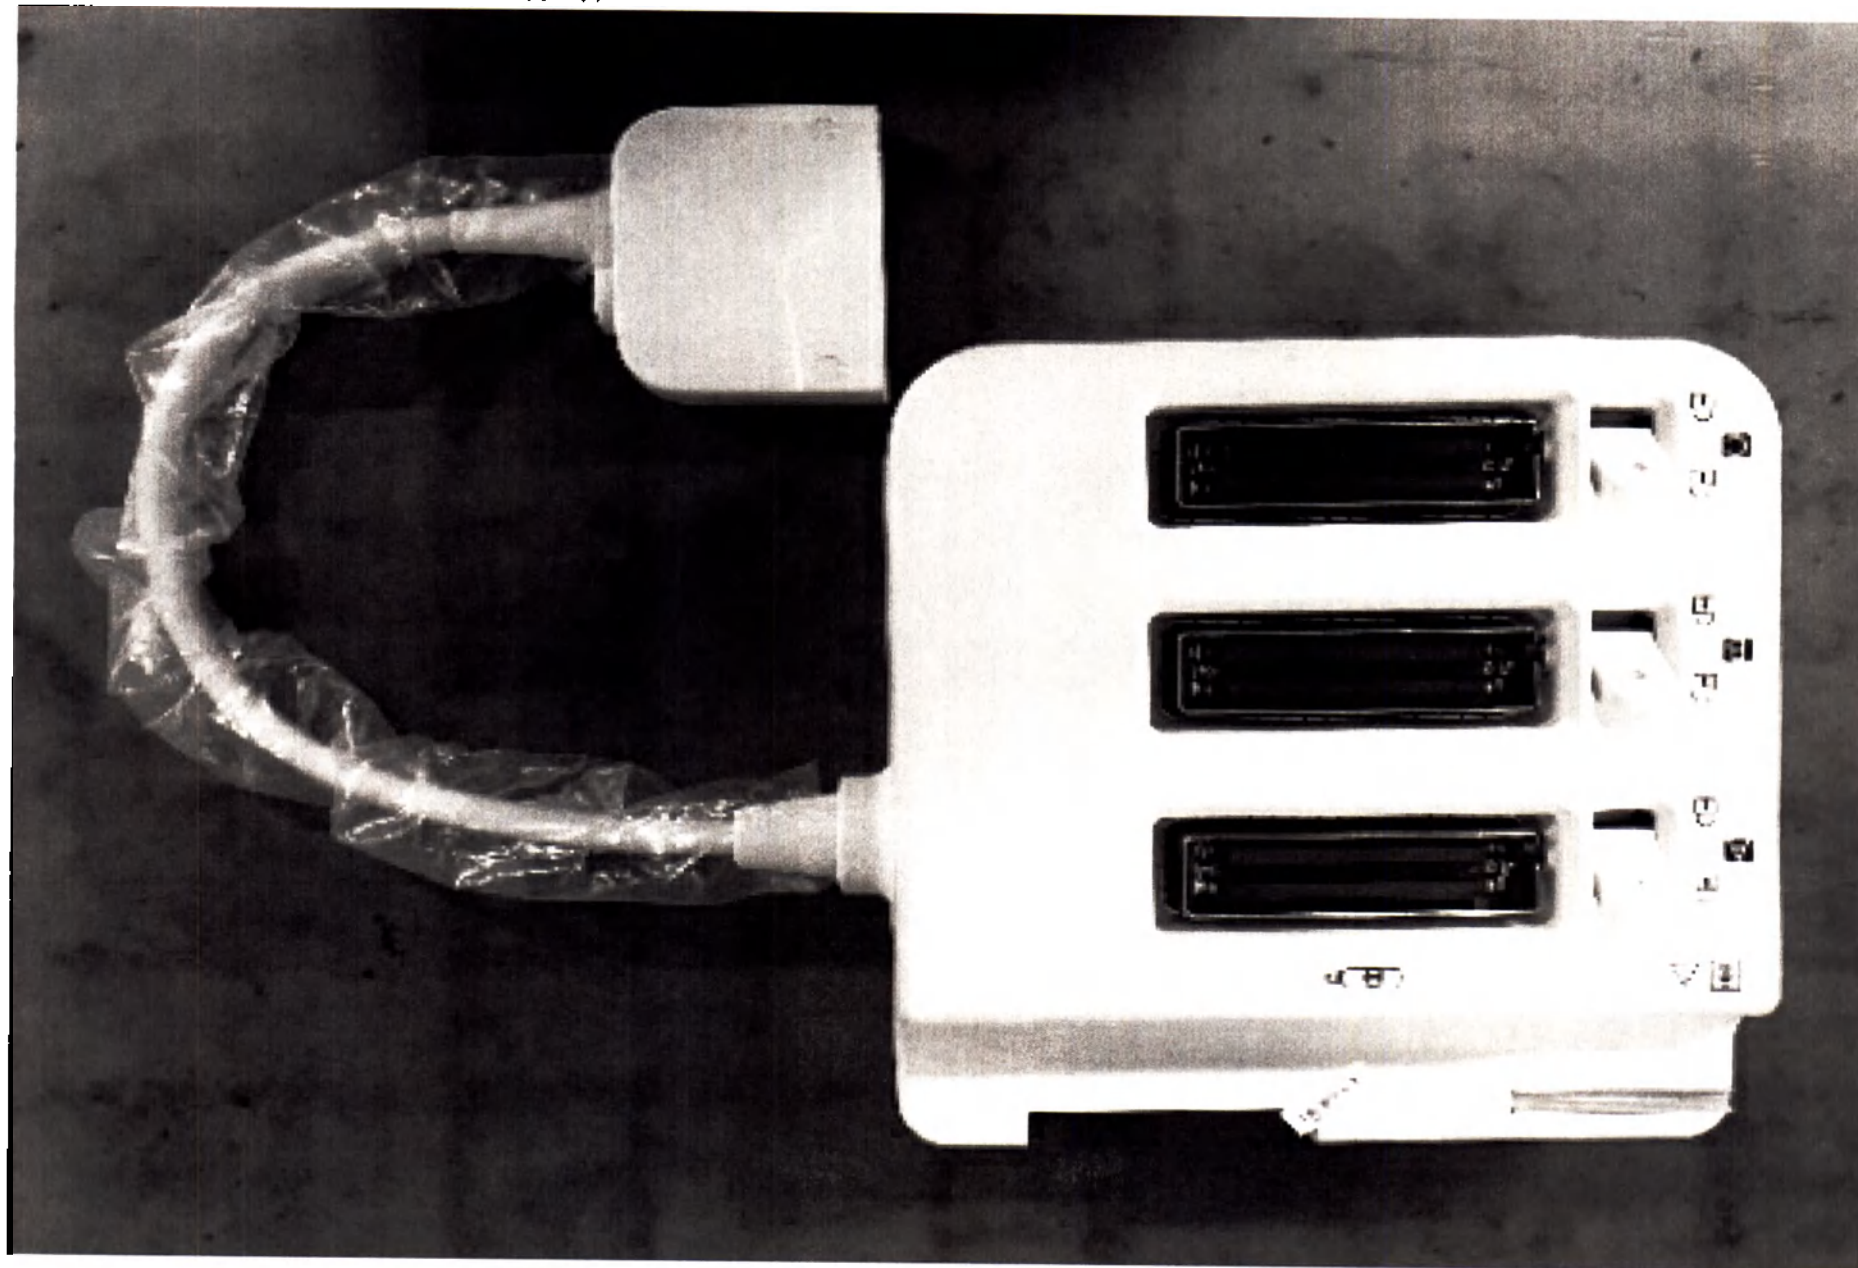


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

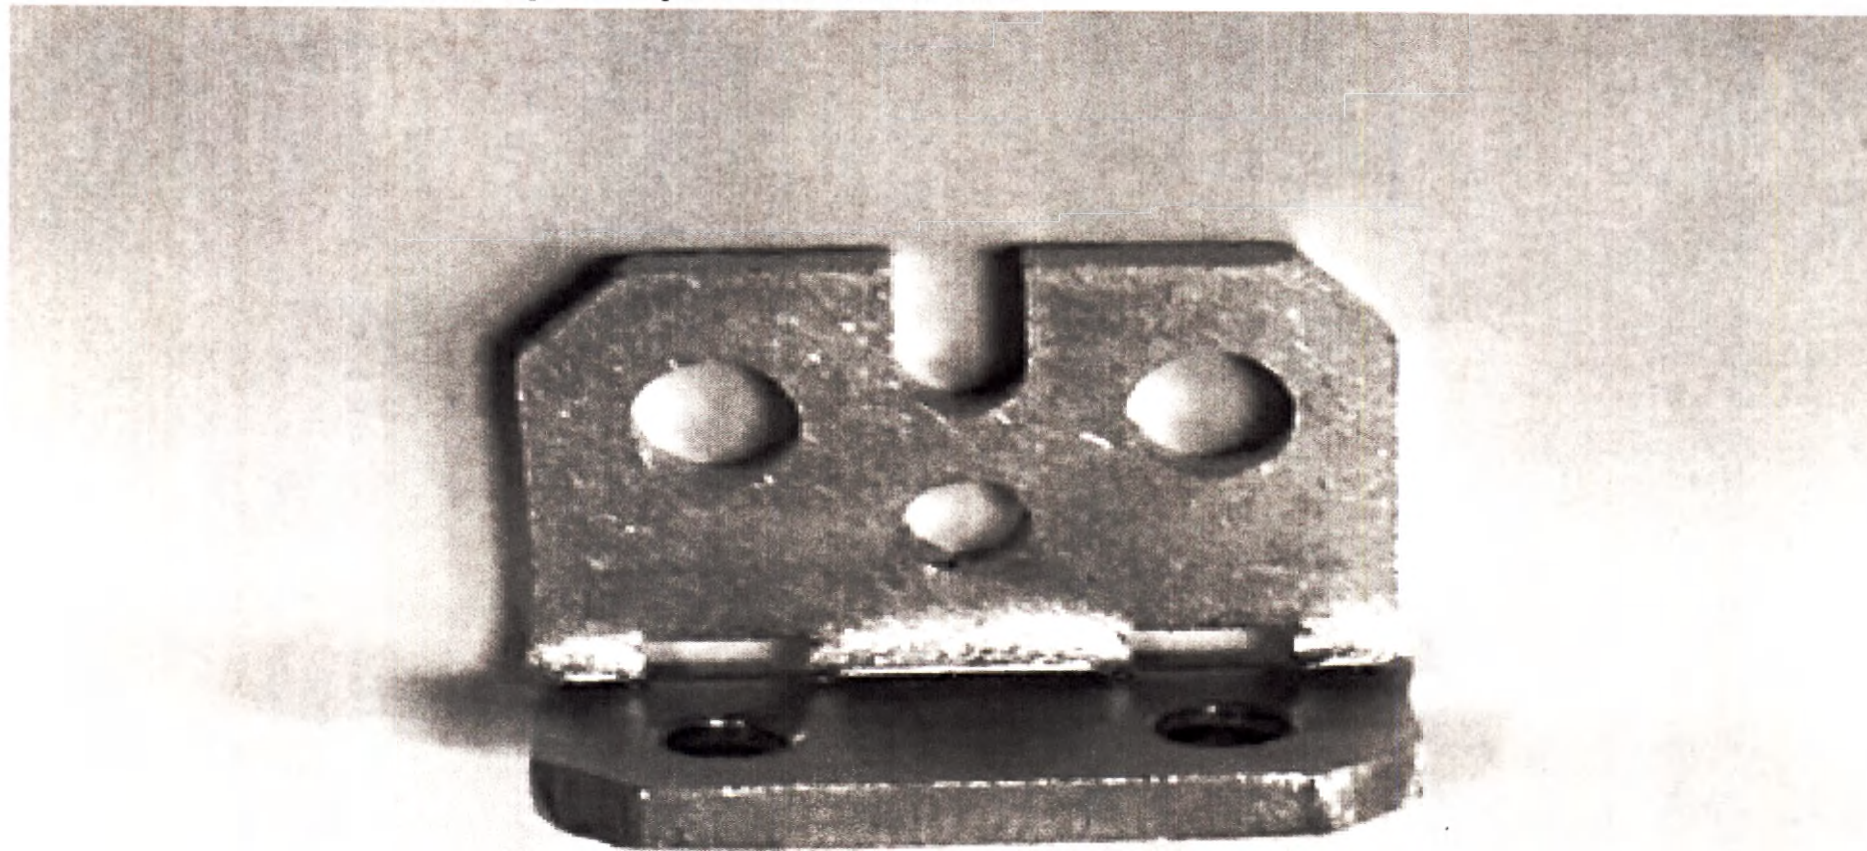

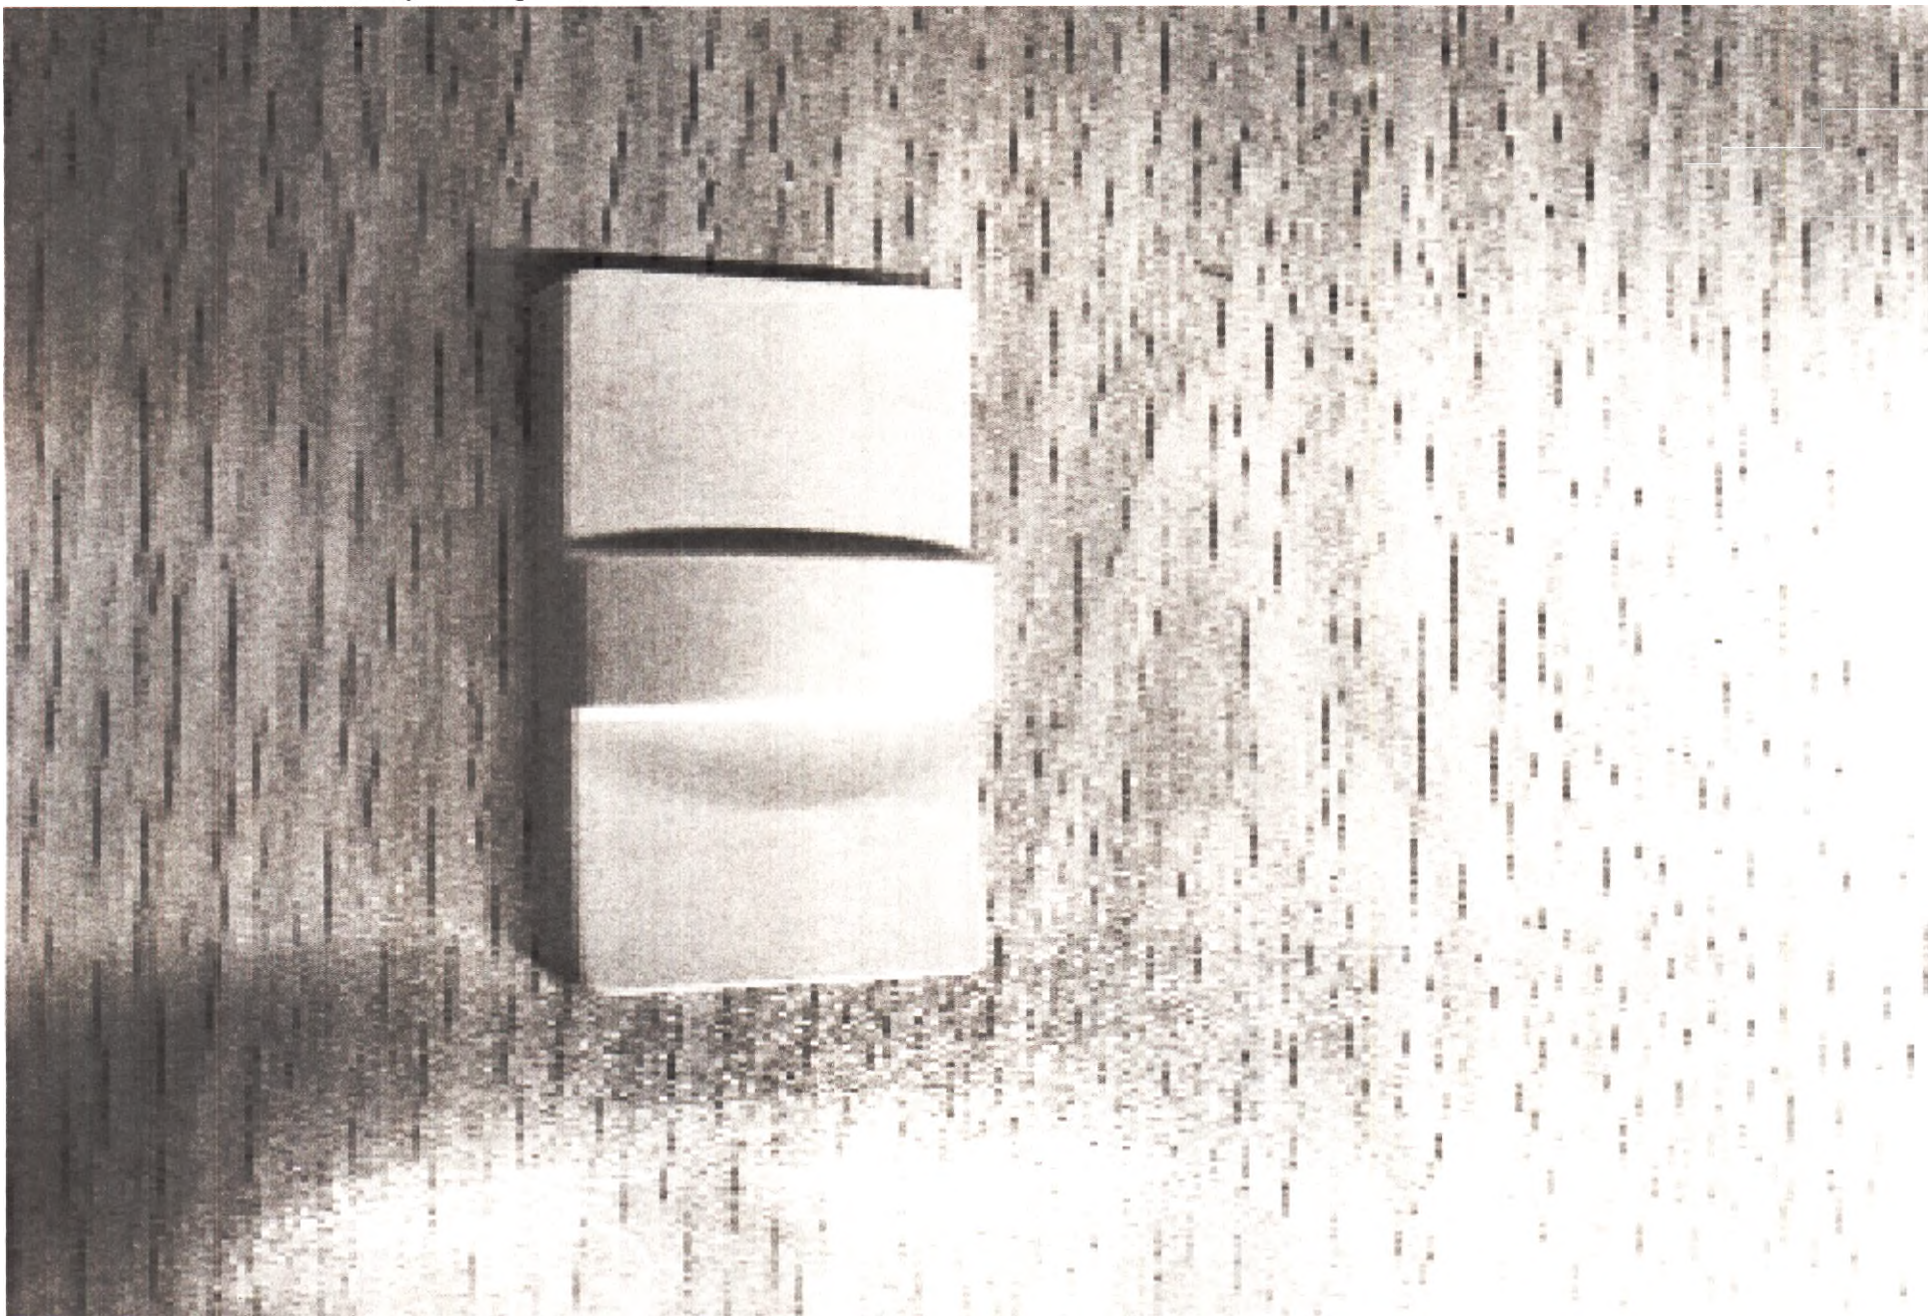



11. Шайба плоская

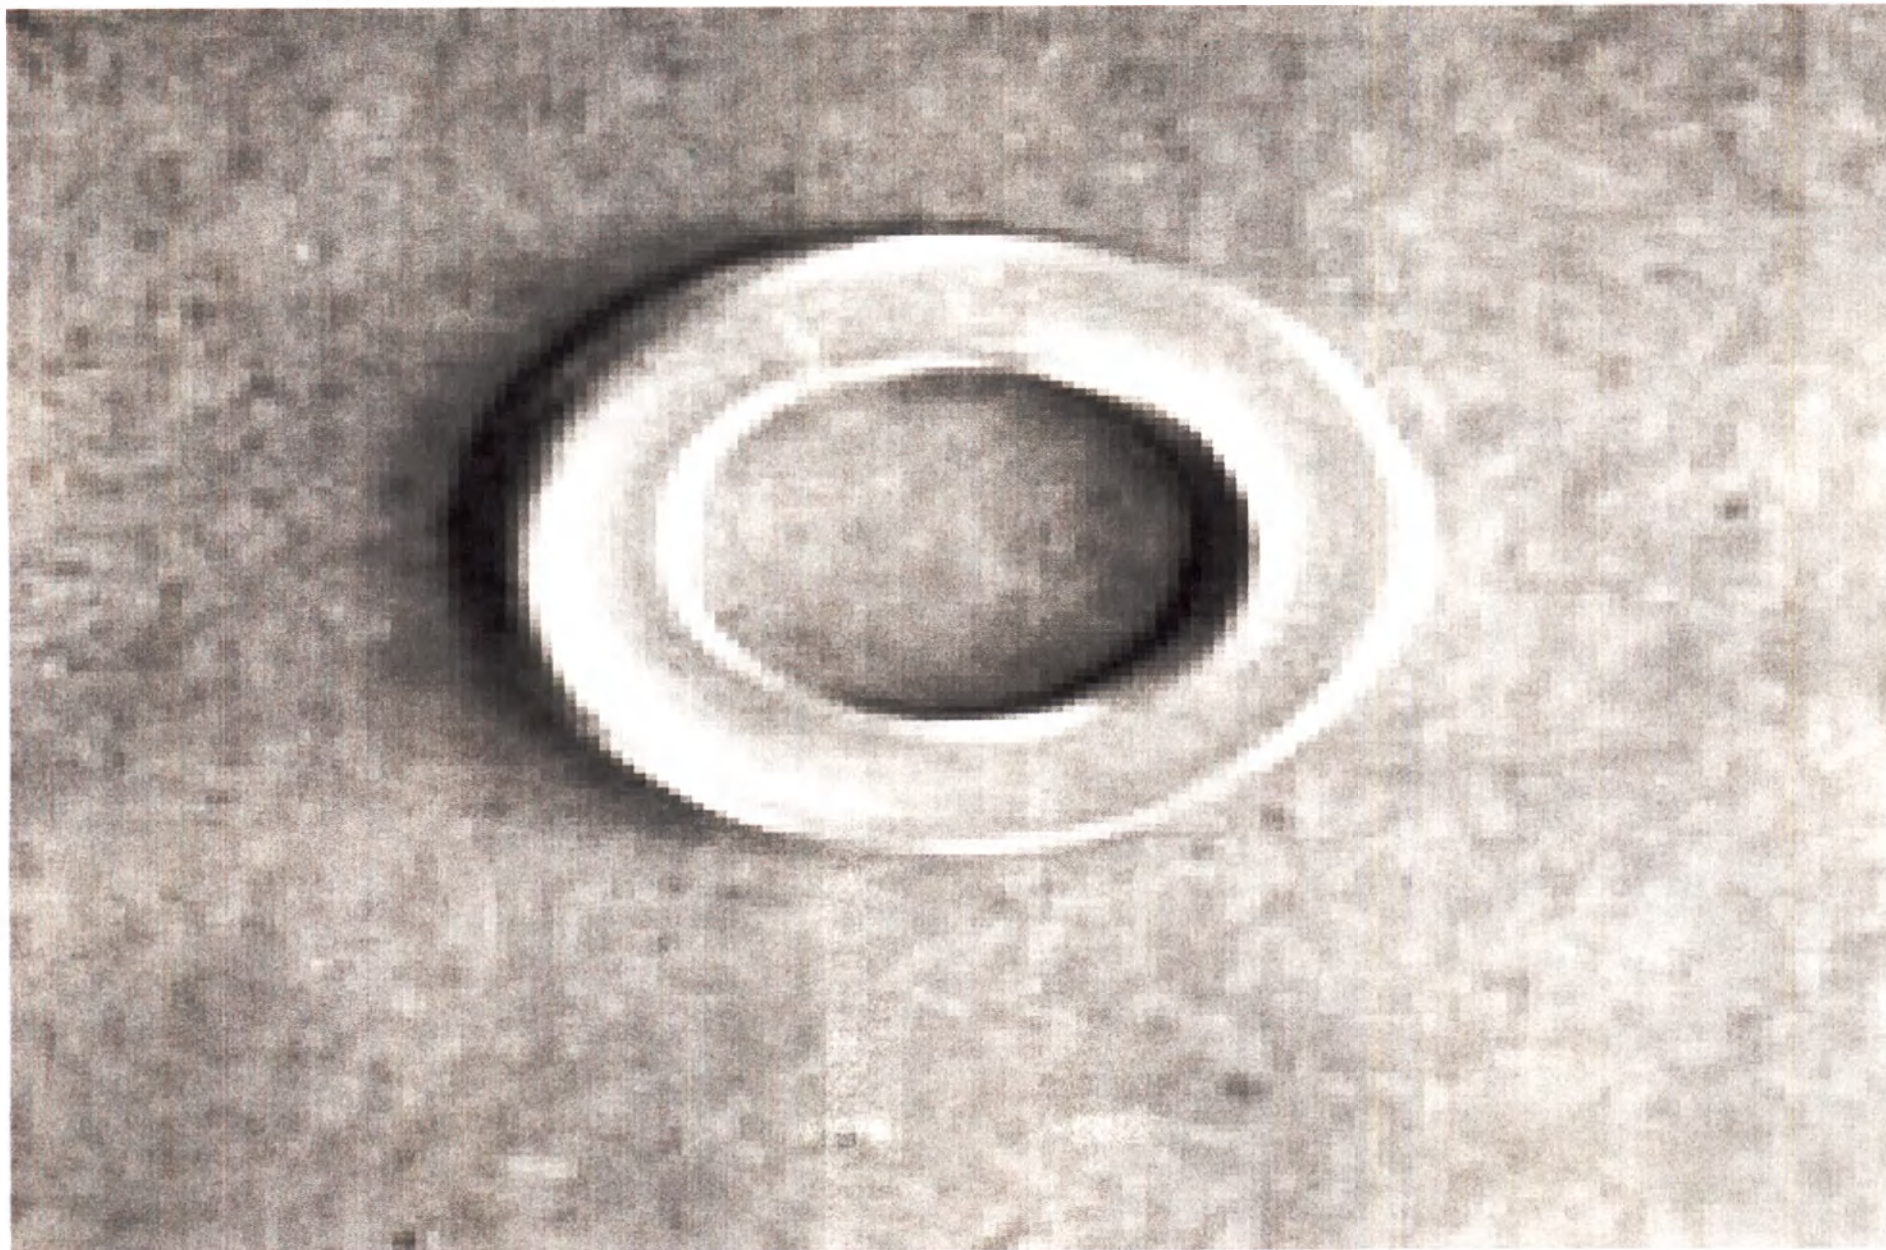



13. Винт с головкой под шестигранный ключ

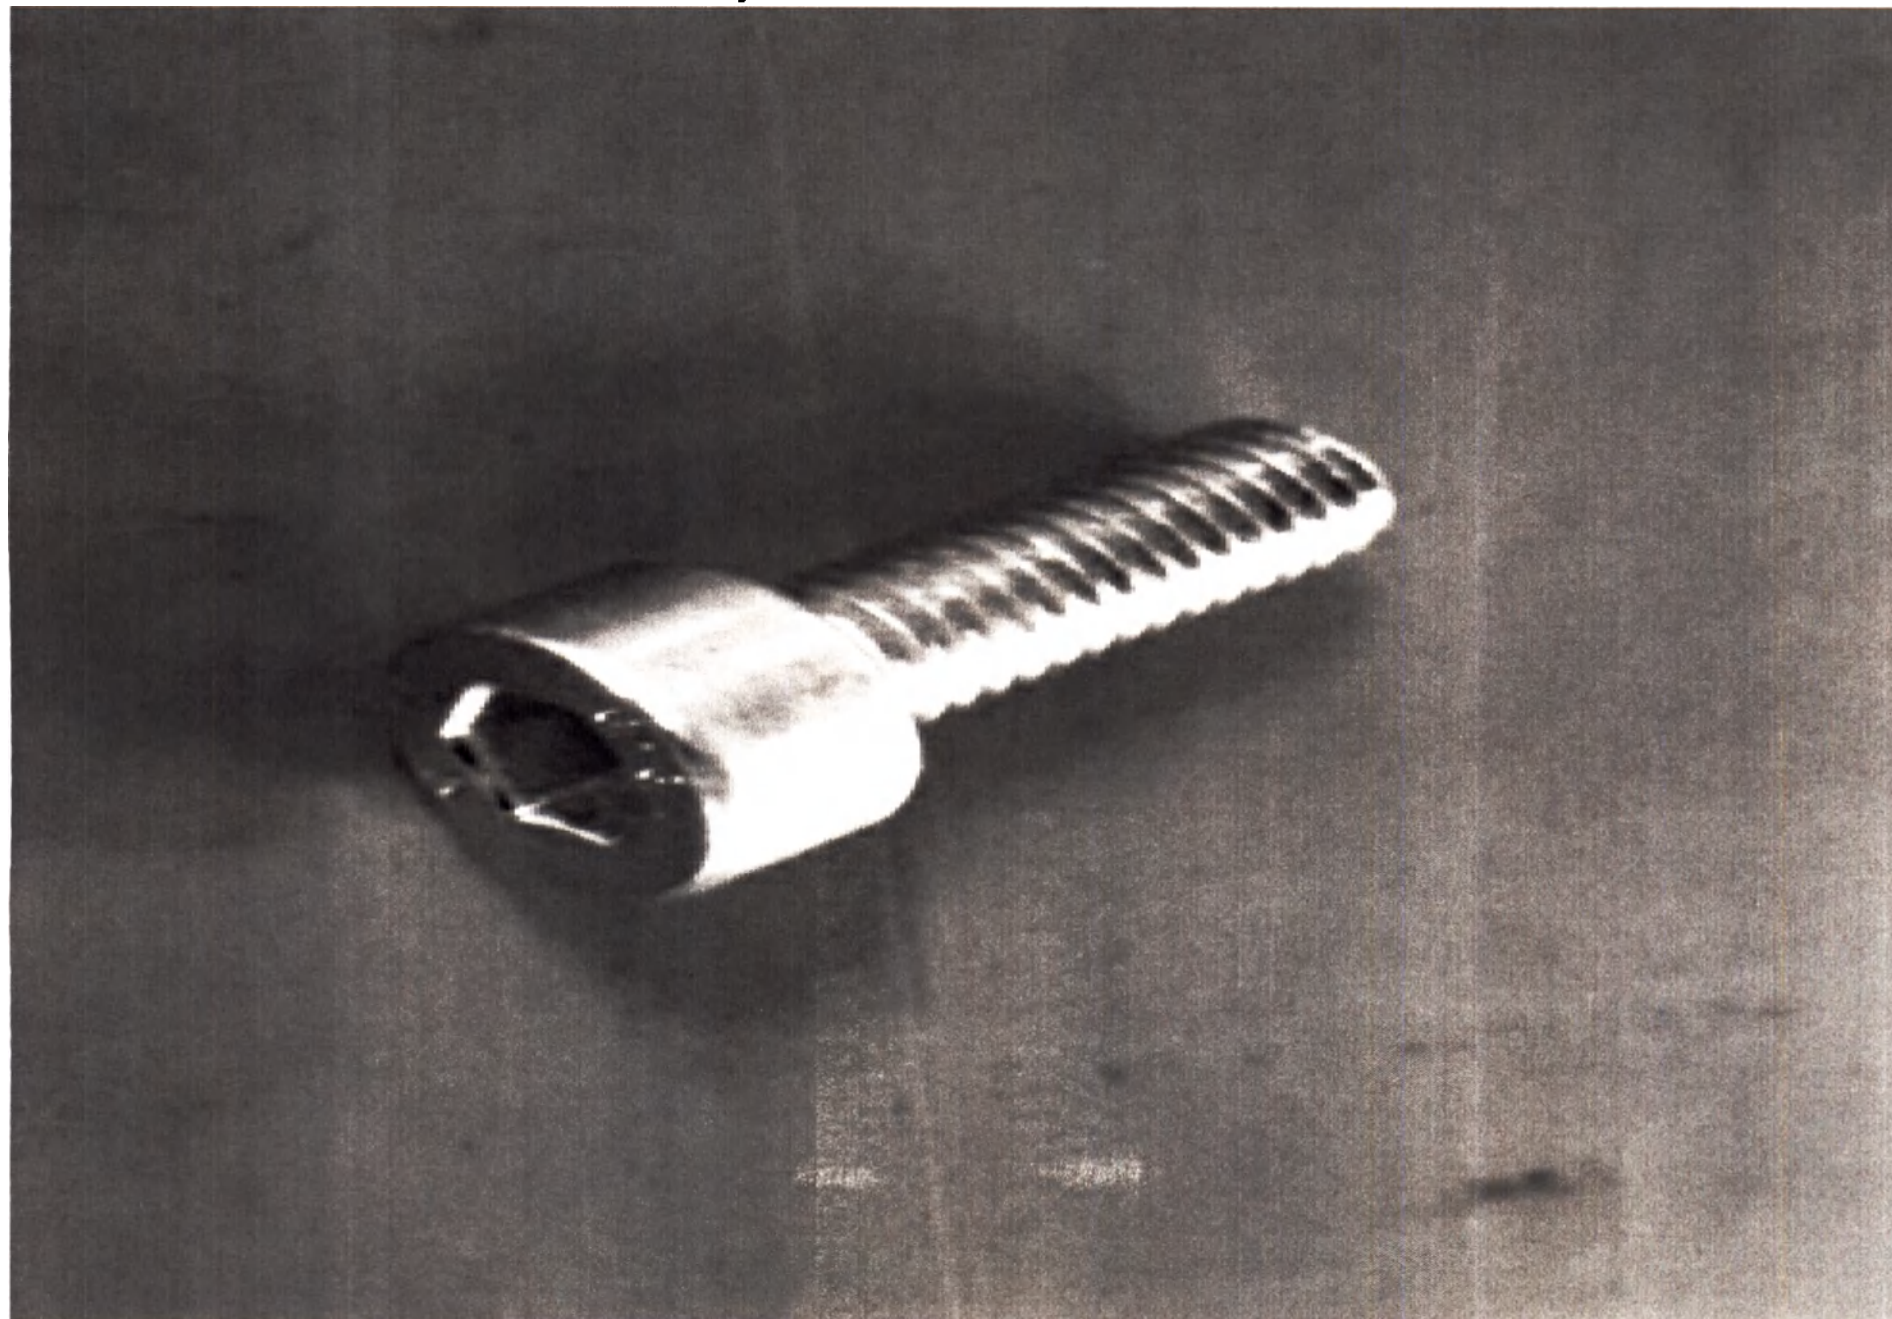


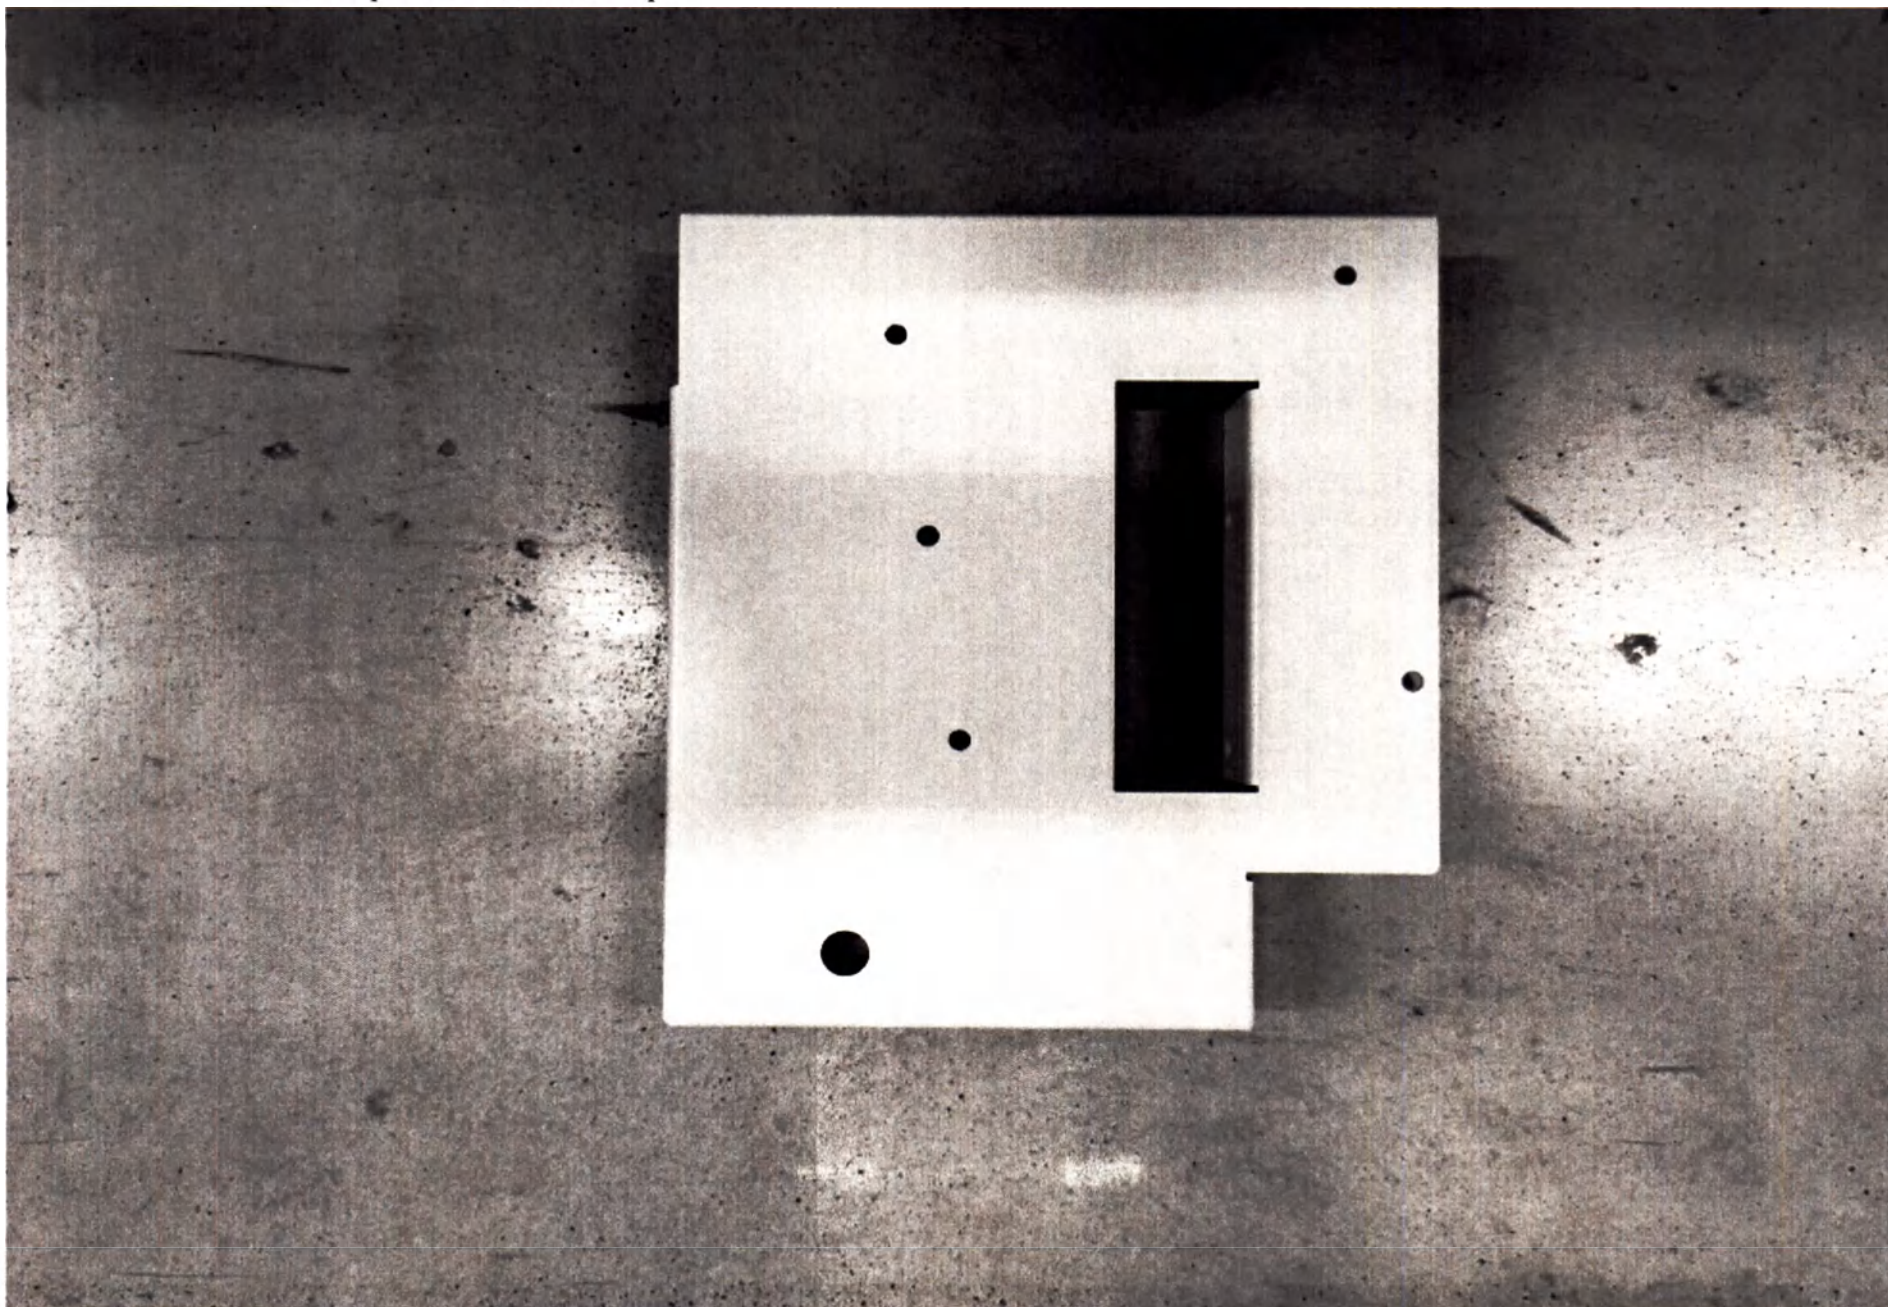


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку



16. Беспроводной USB-адаптер

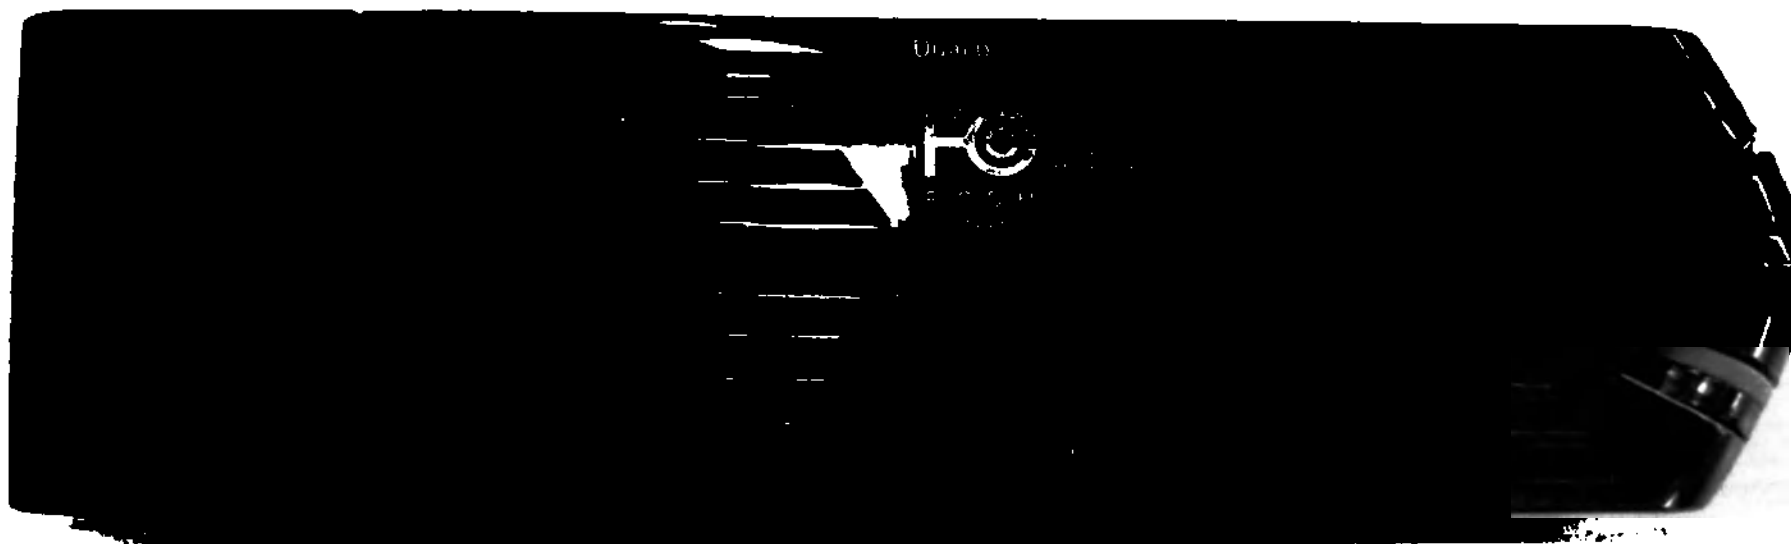


17. Модуль расширения портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов

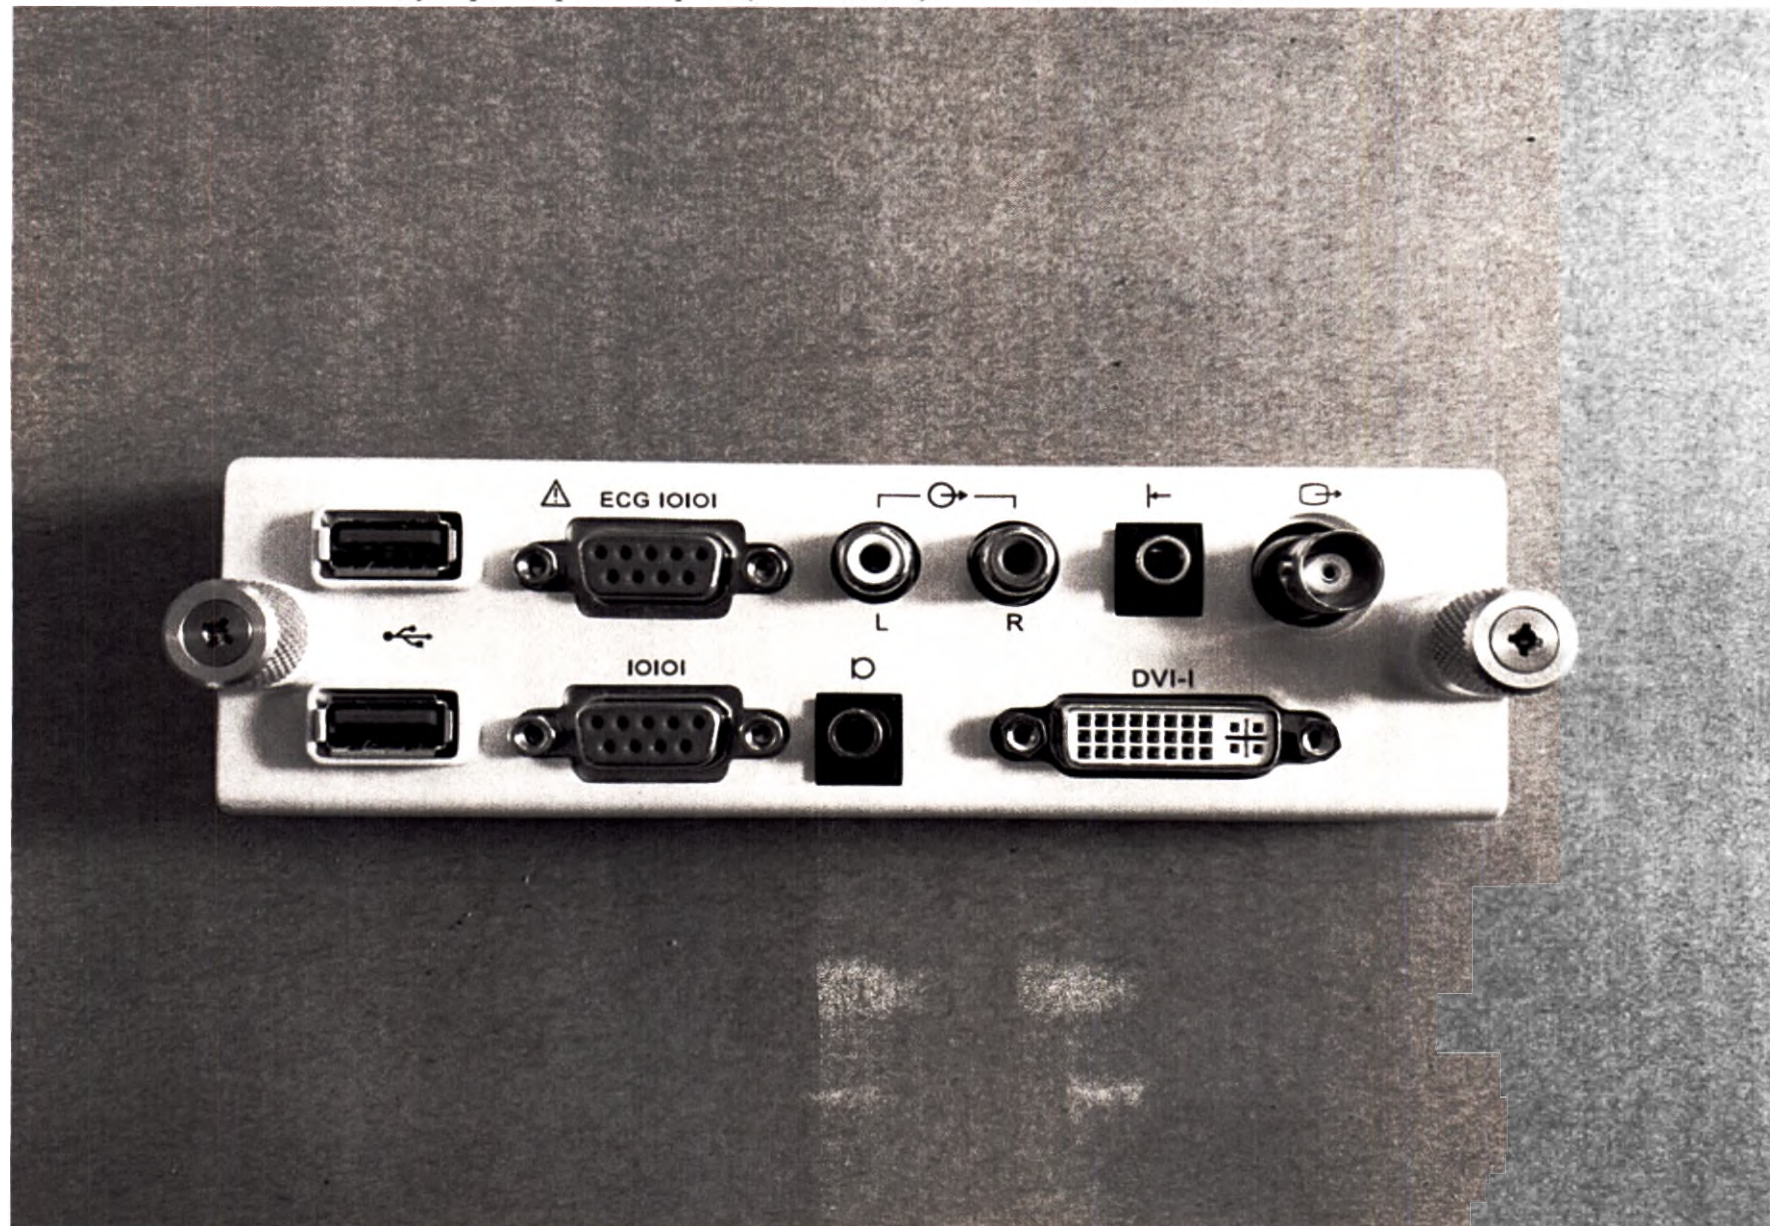


18. Кабель BNC




19. Кабель пульта дистанционного управления принтером

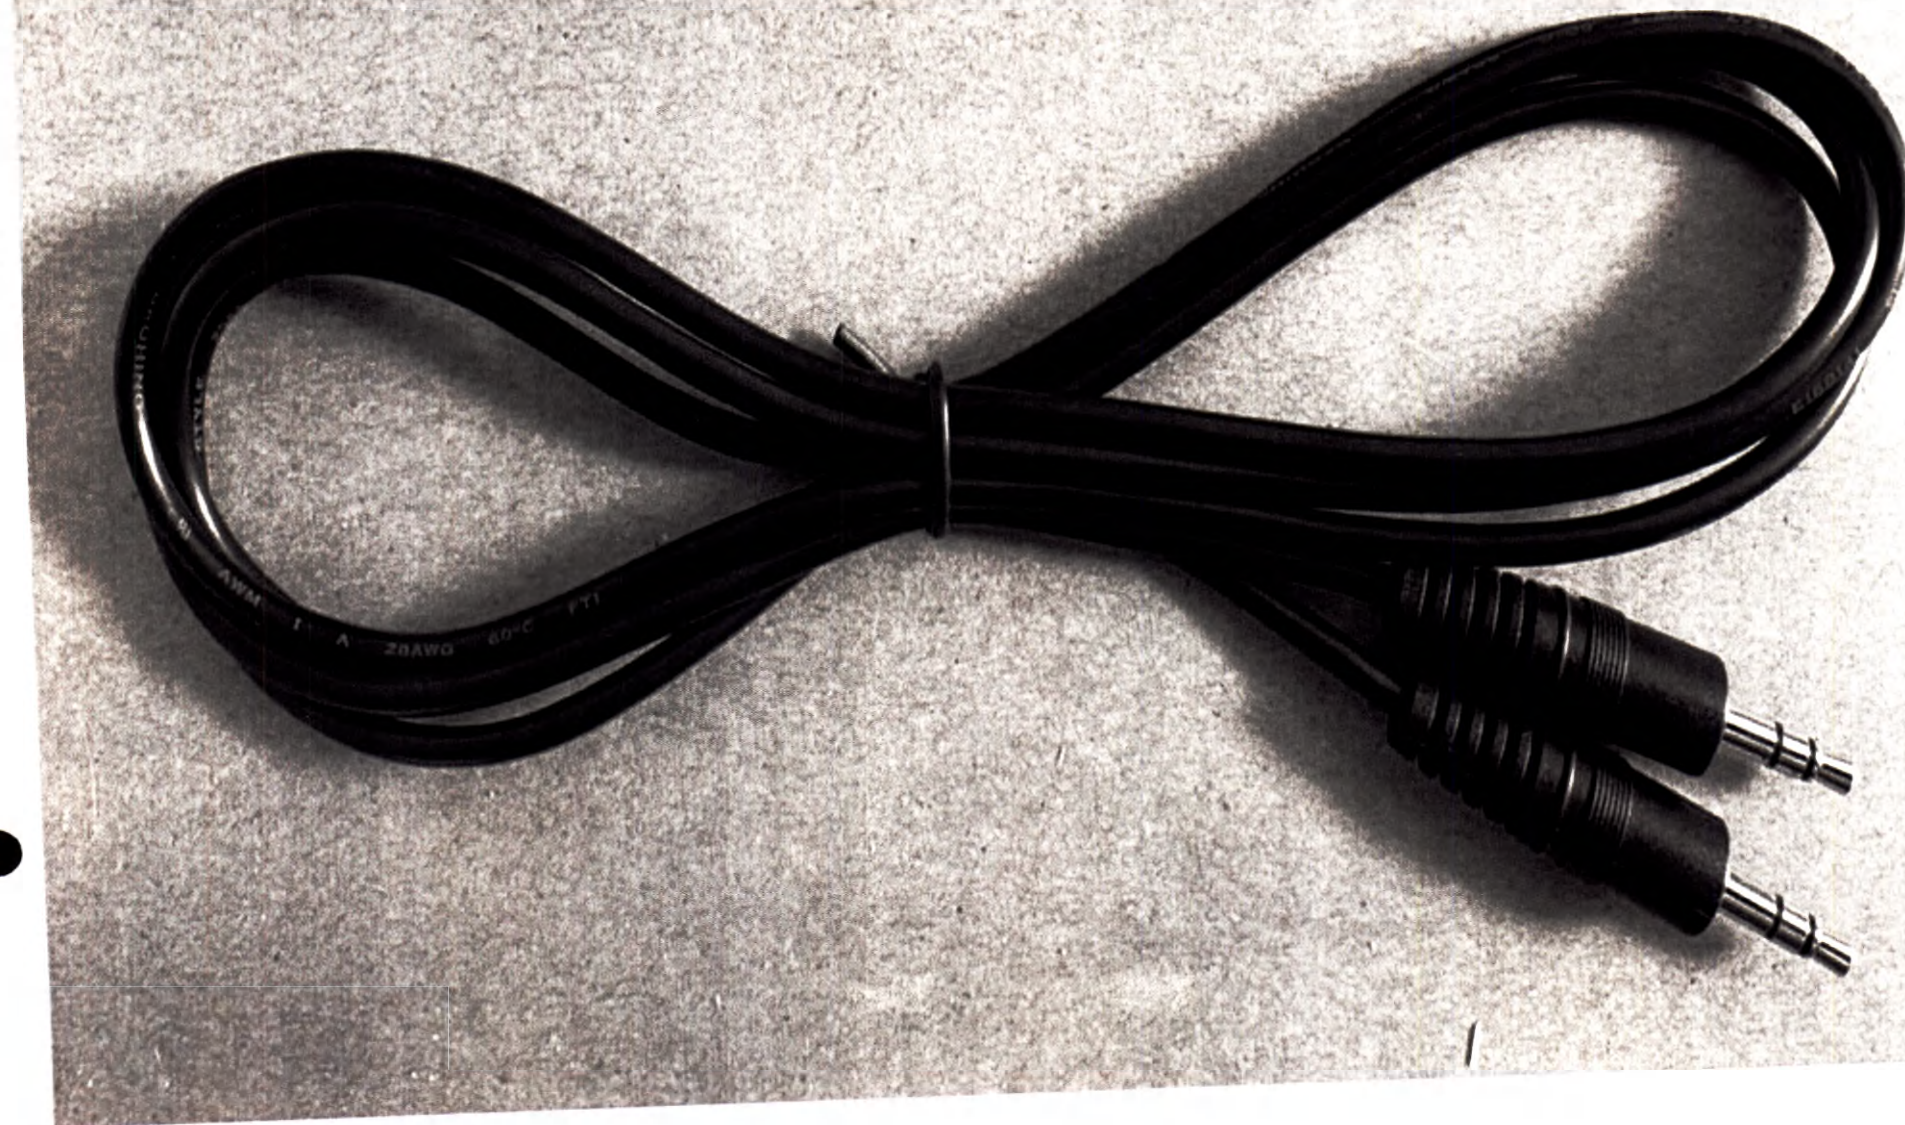

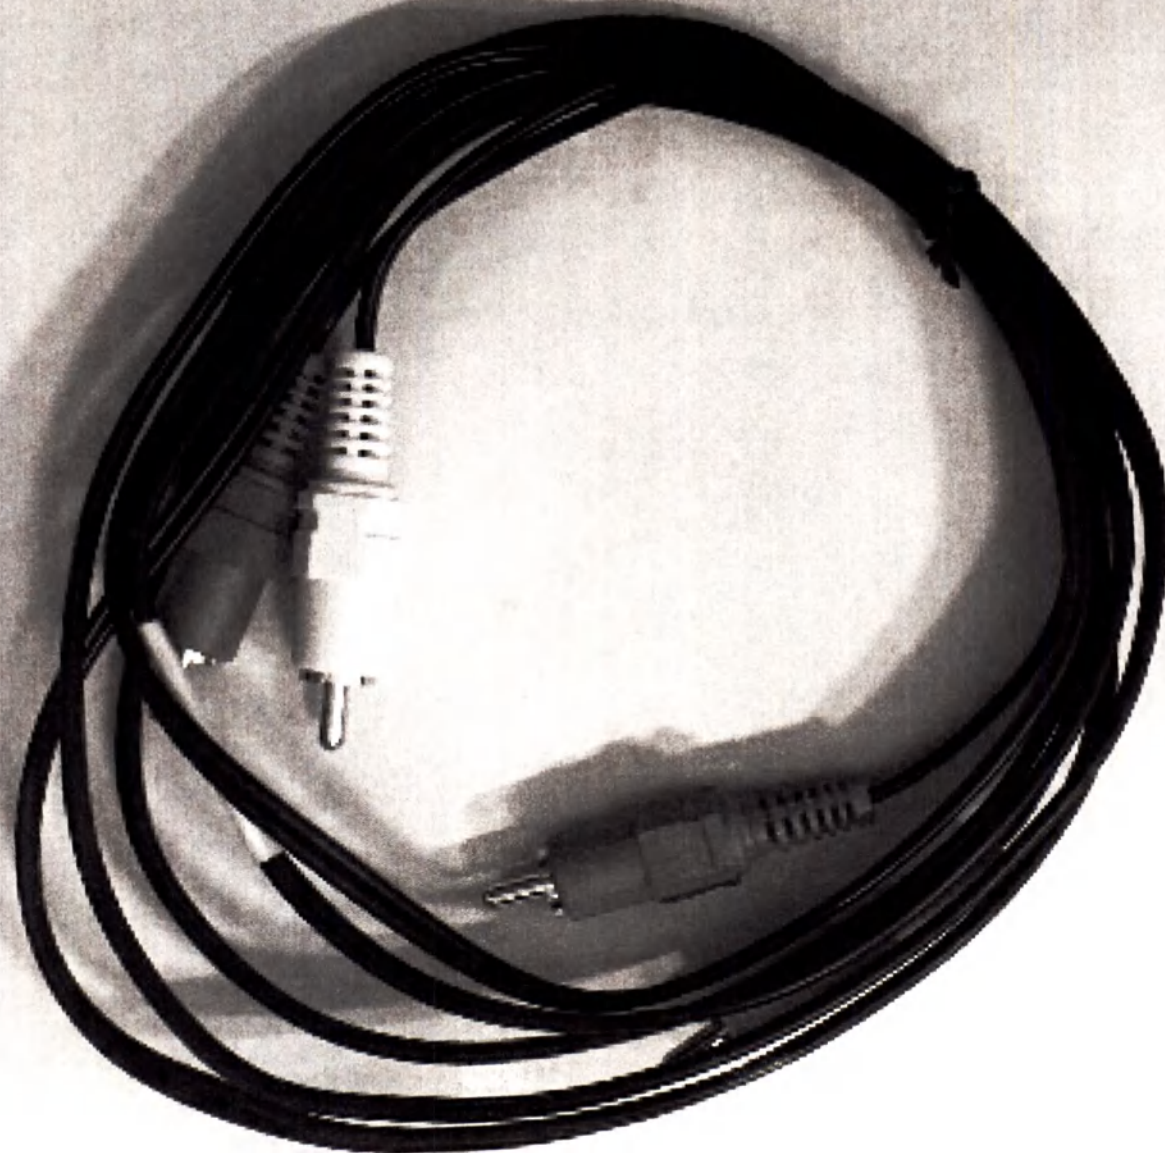




22. Накладка на панель управления защитная

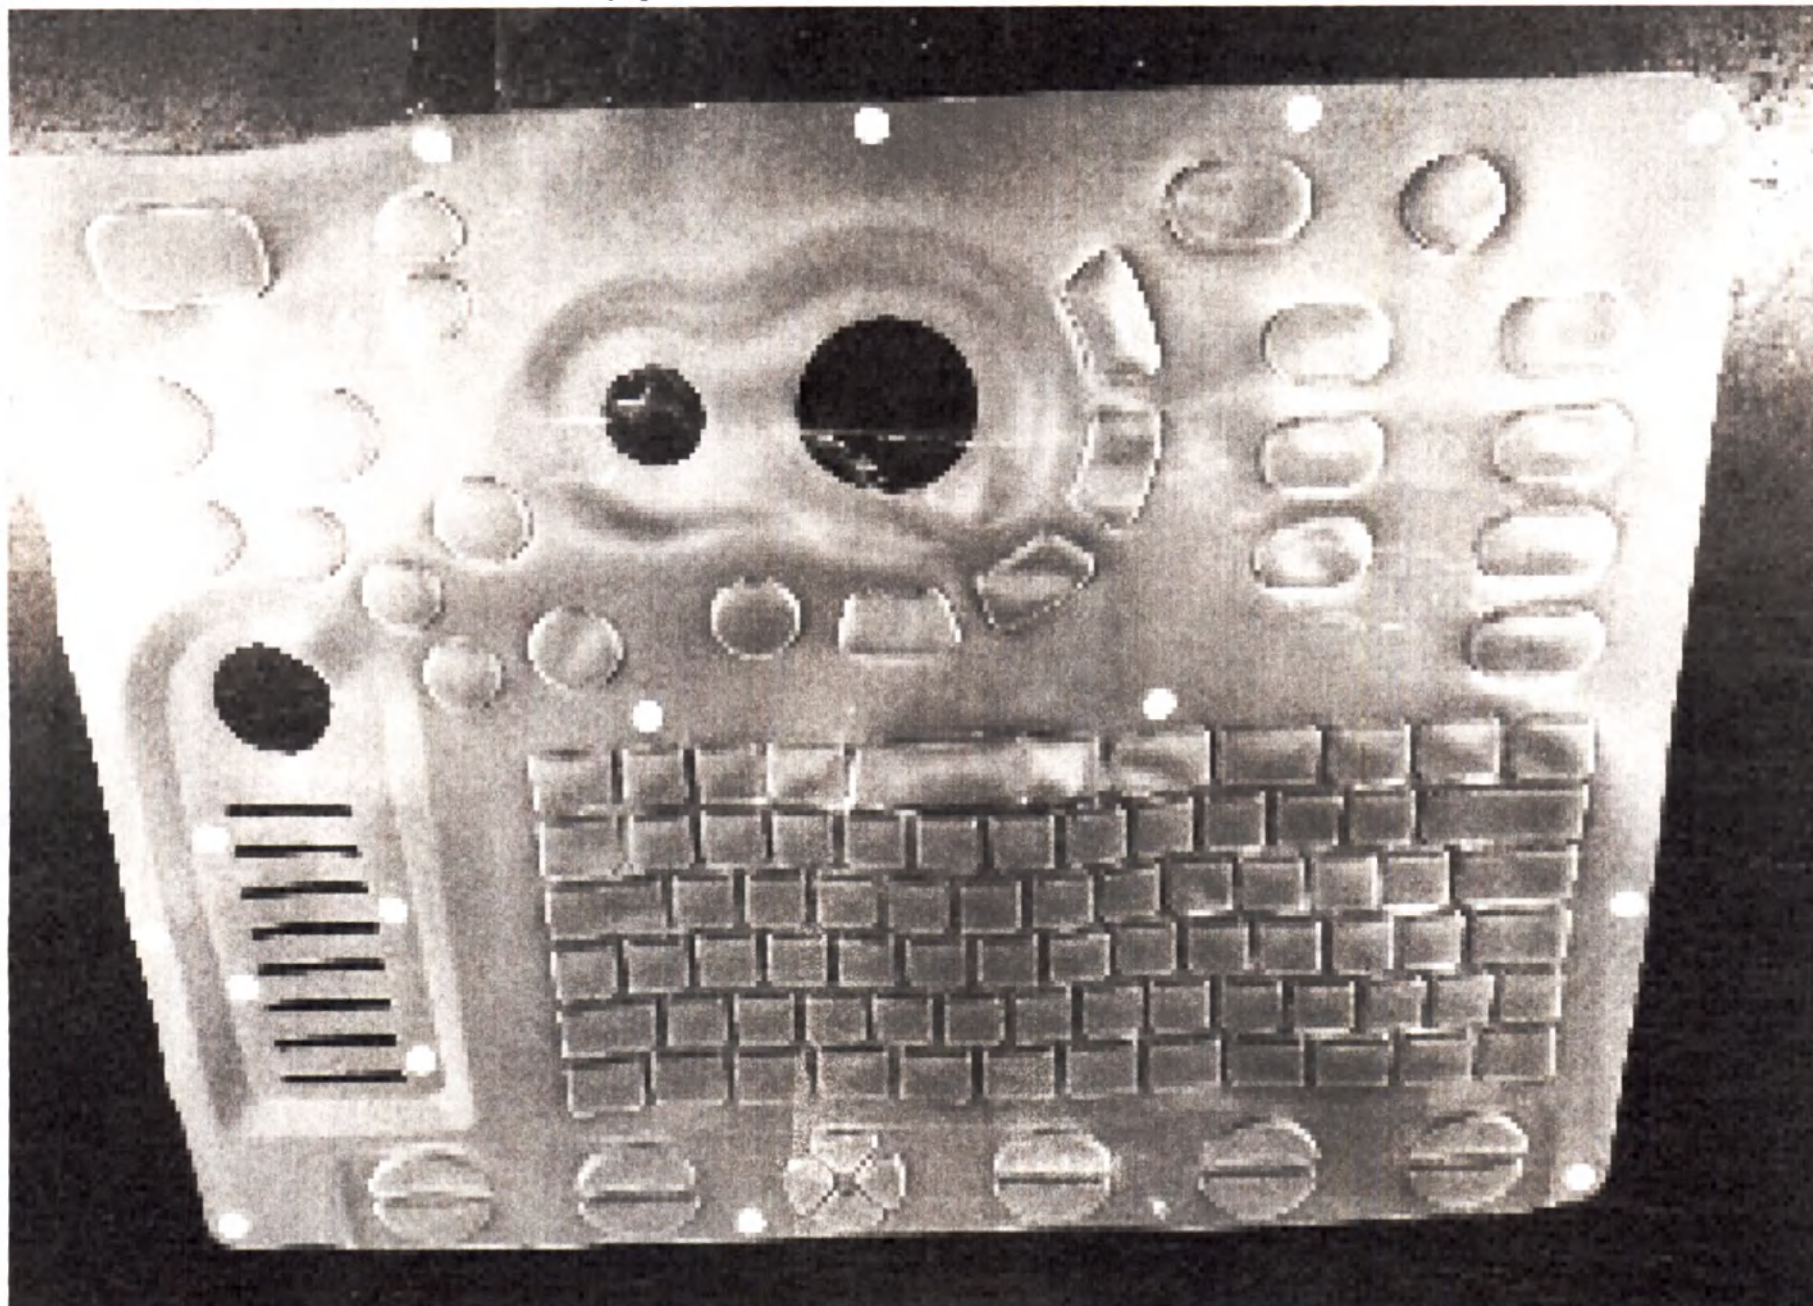




24. Датчики ультразвуковые

24.1. Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s

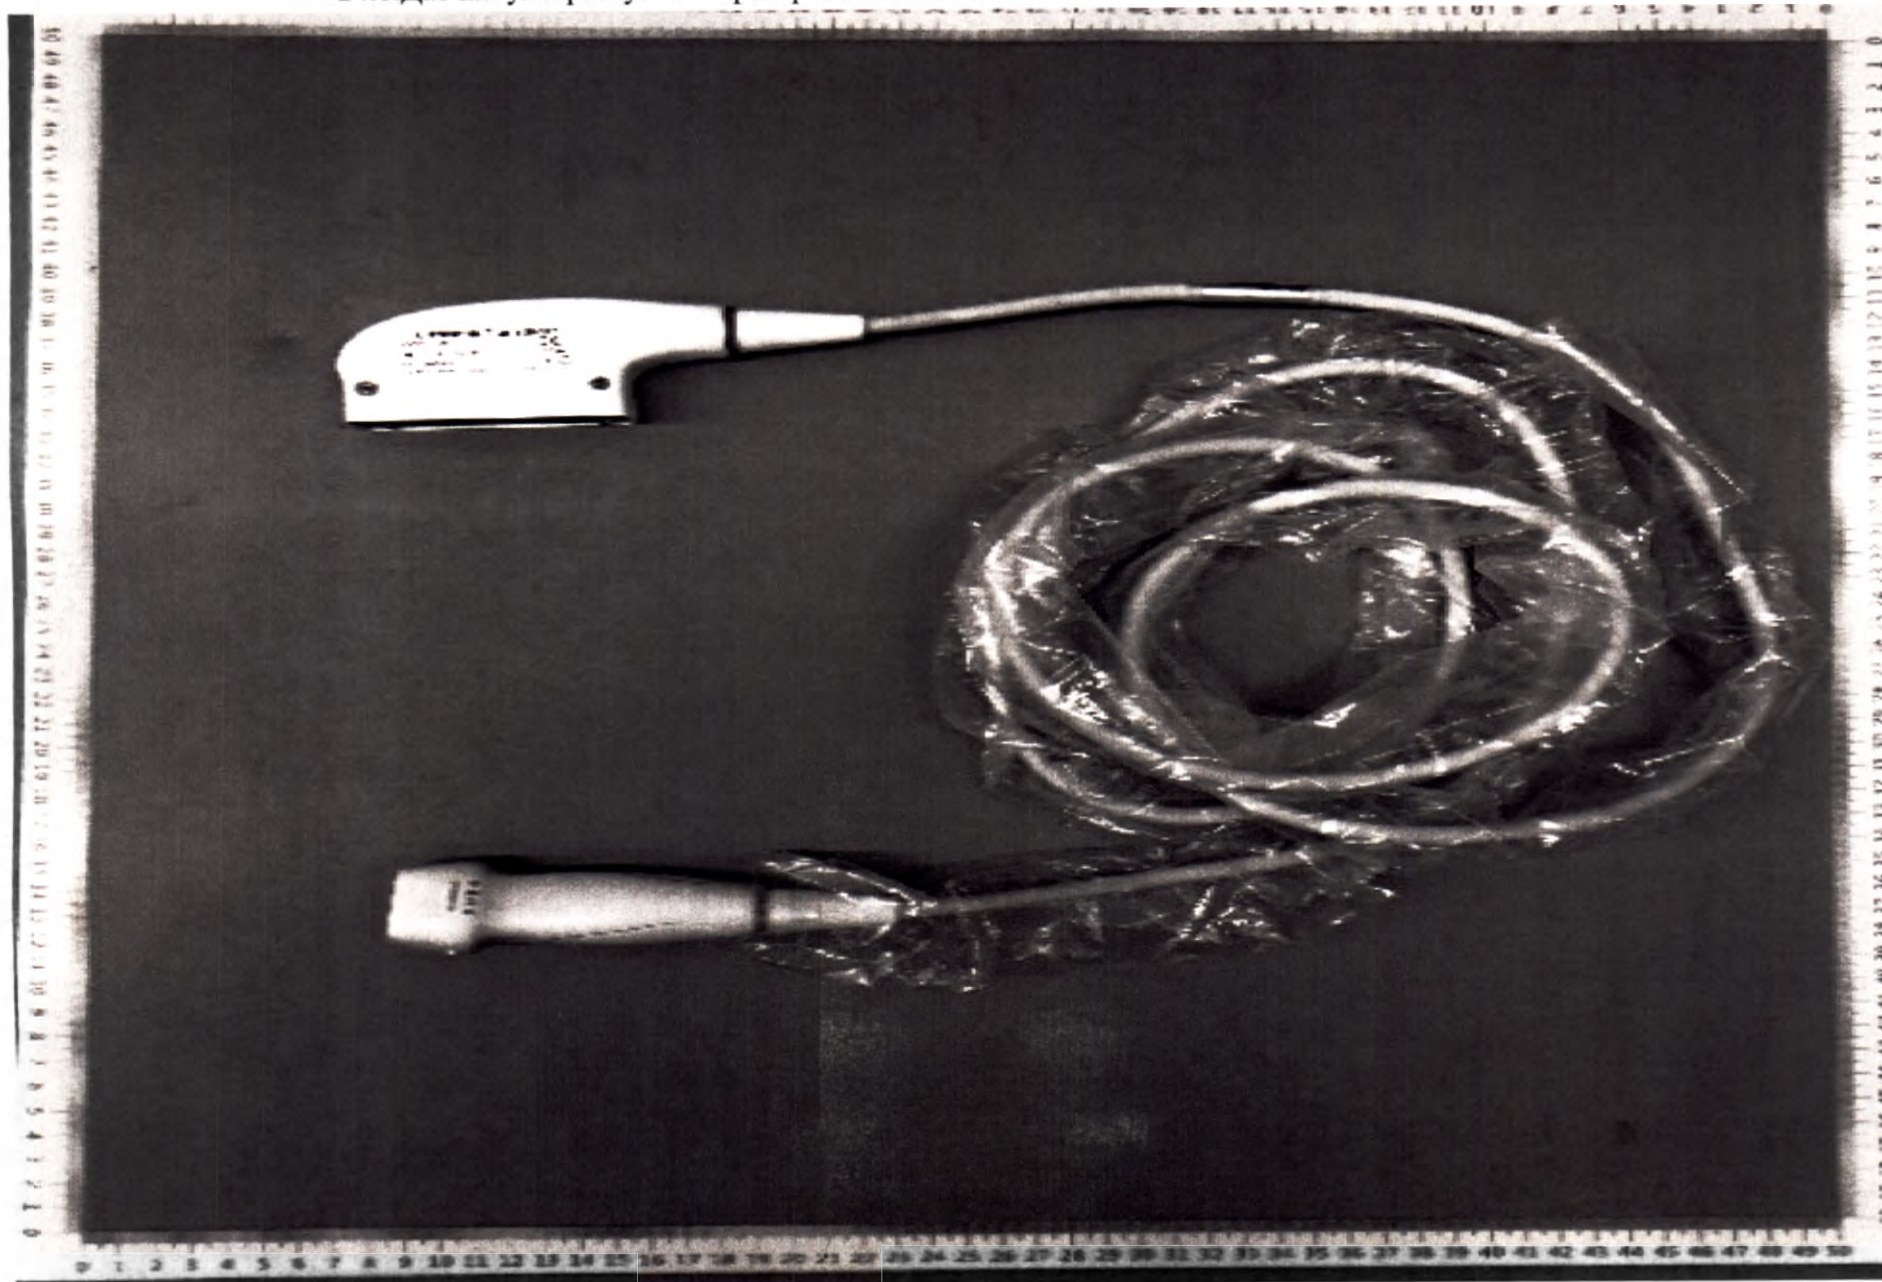



24.2. Датчик ультразвуковой конвексный ЗС5s

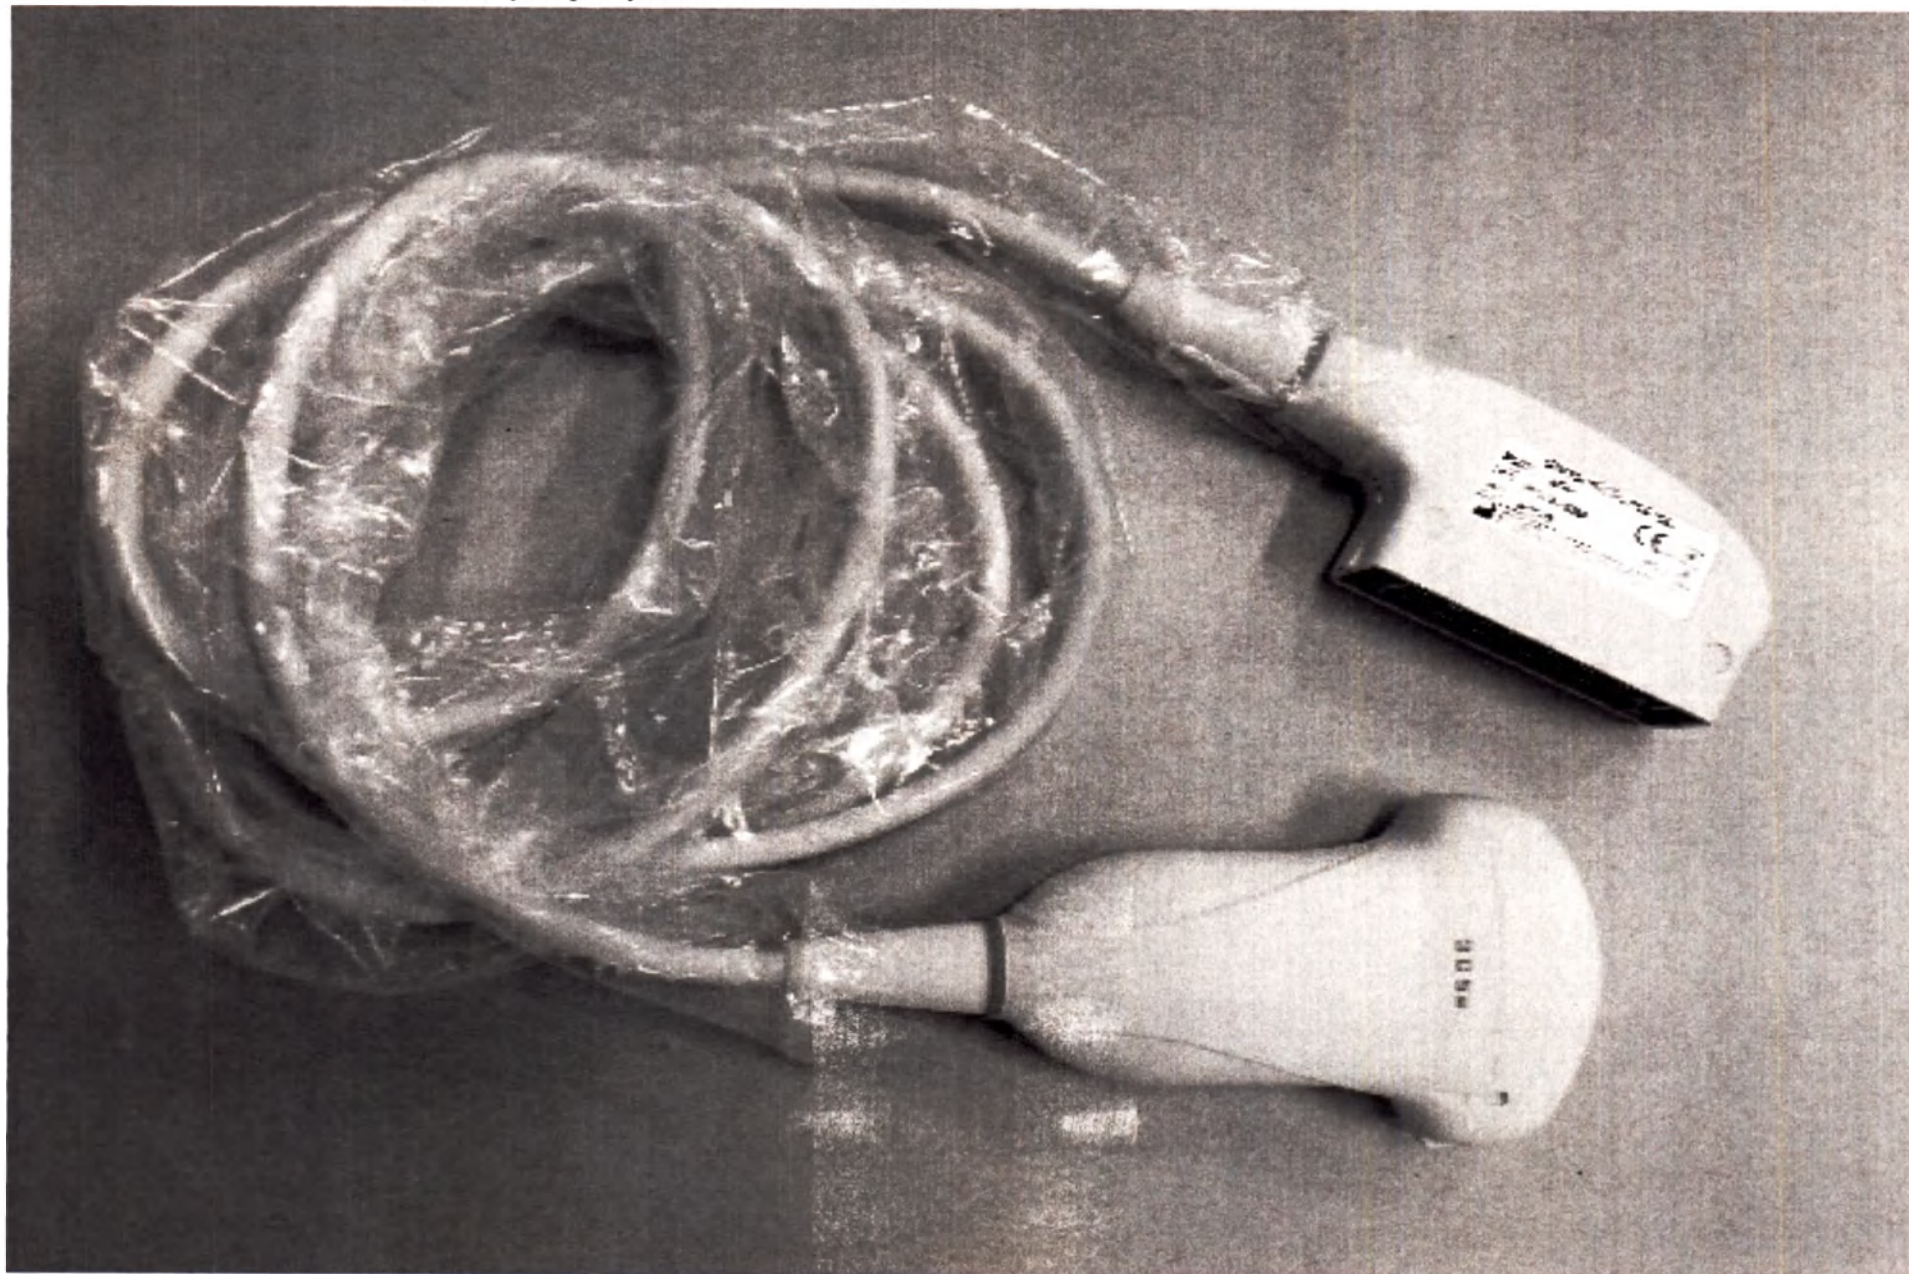



24.3. Датчик ультразвуковой конвексный объемный 4CD4s




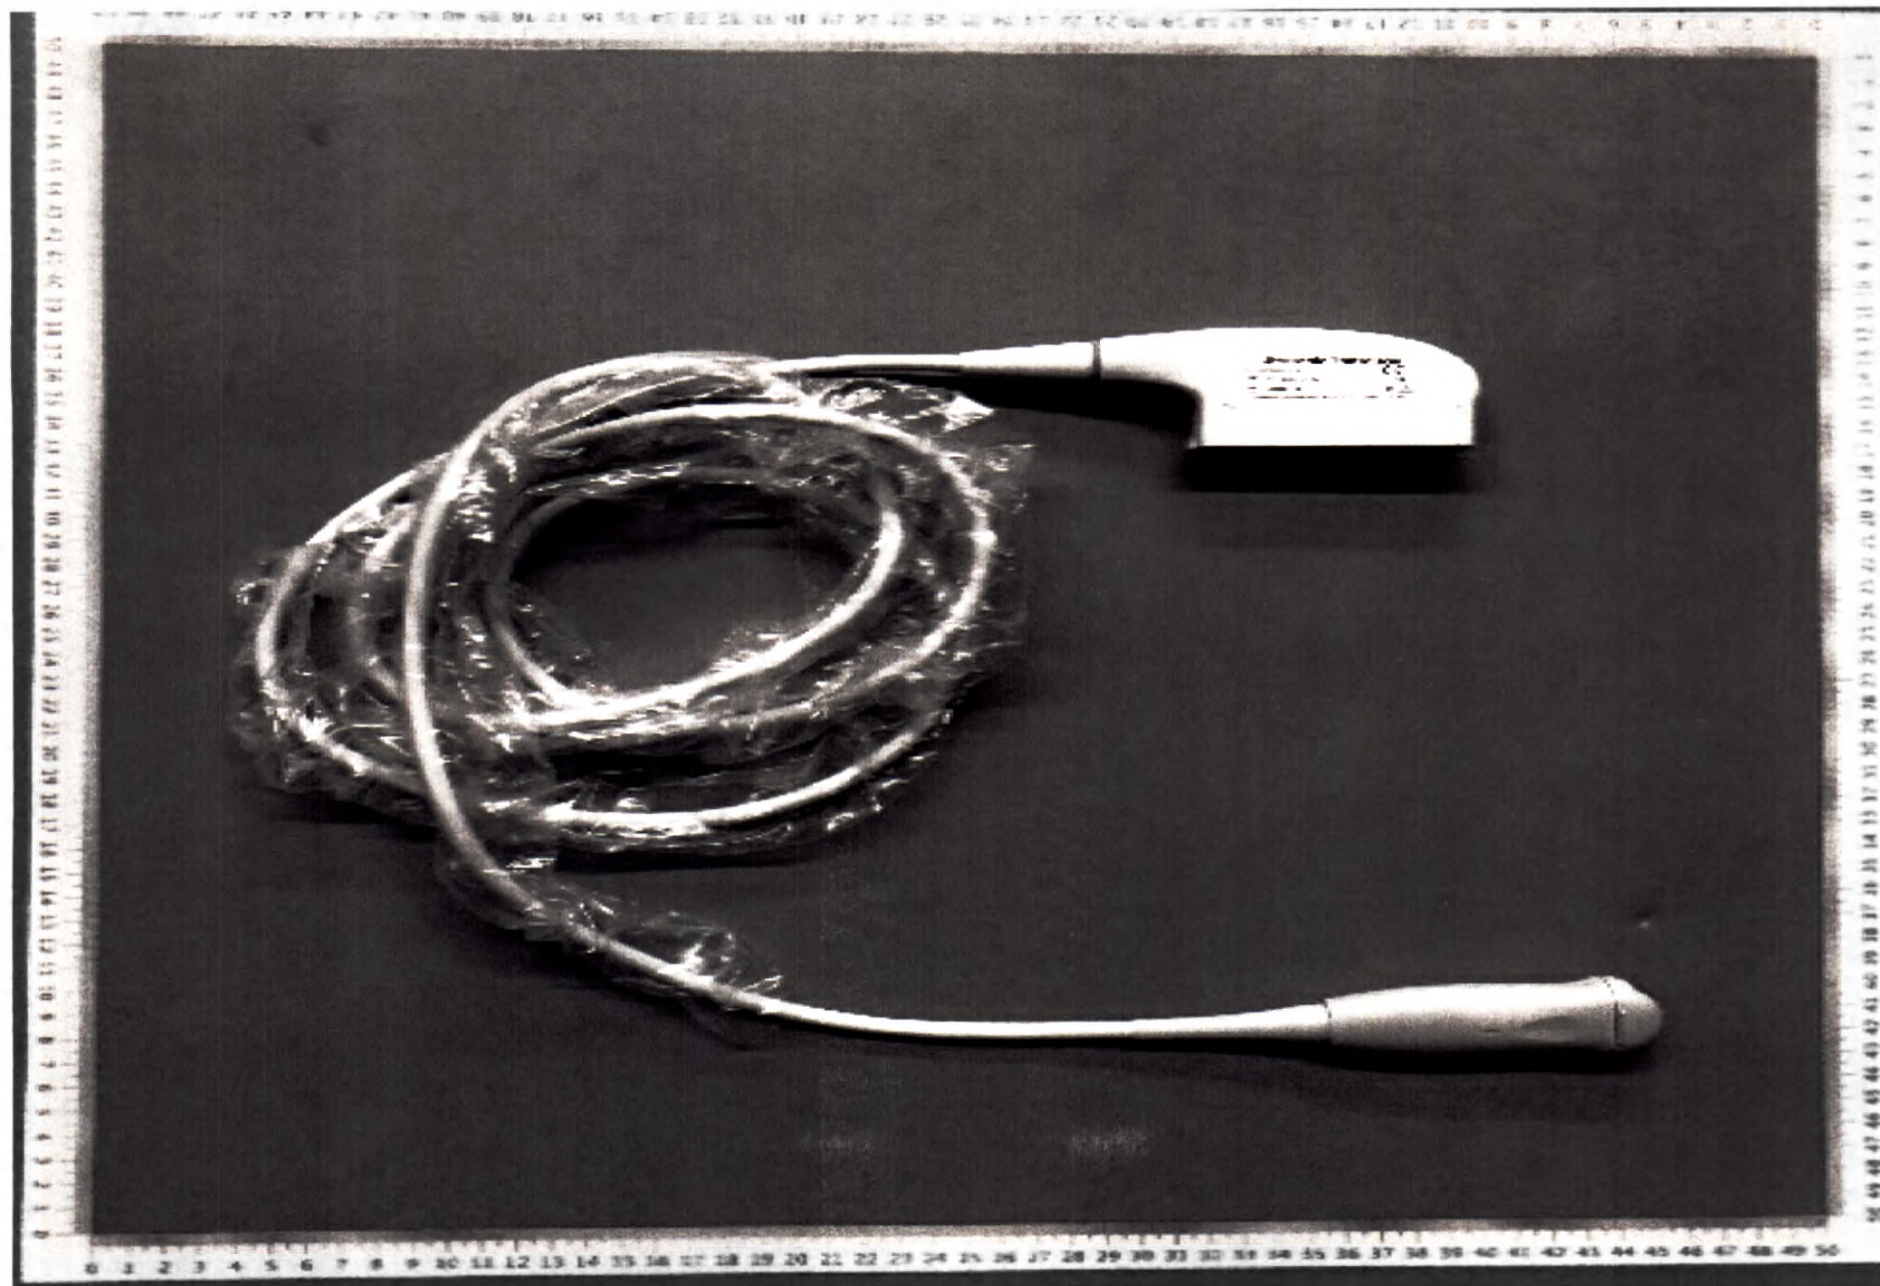


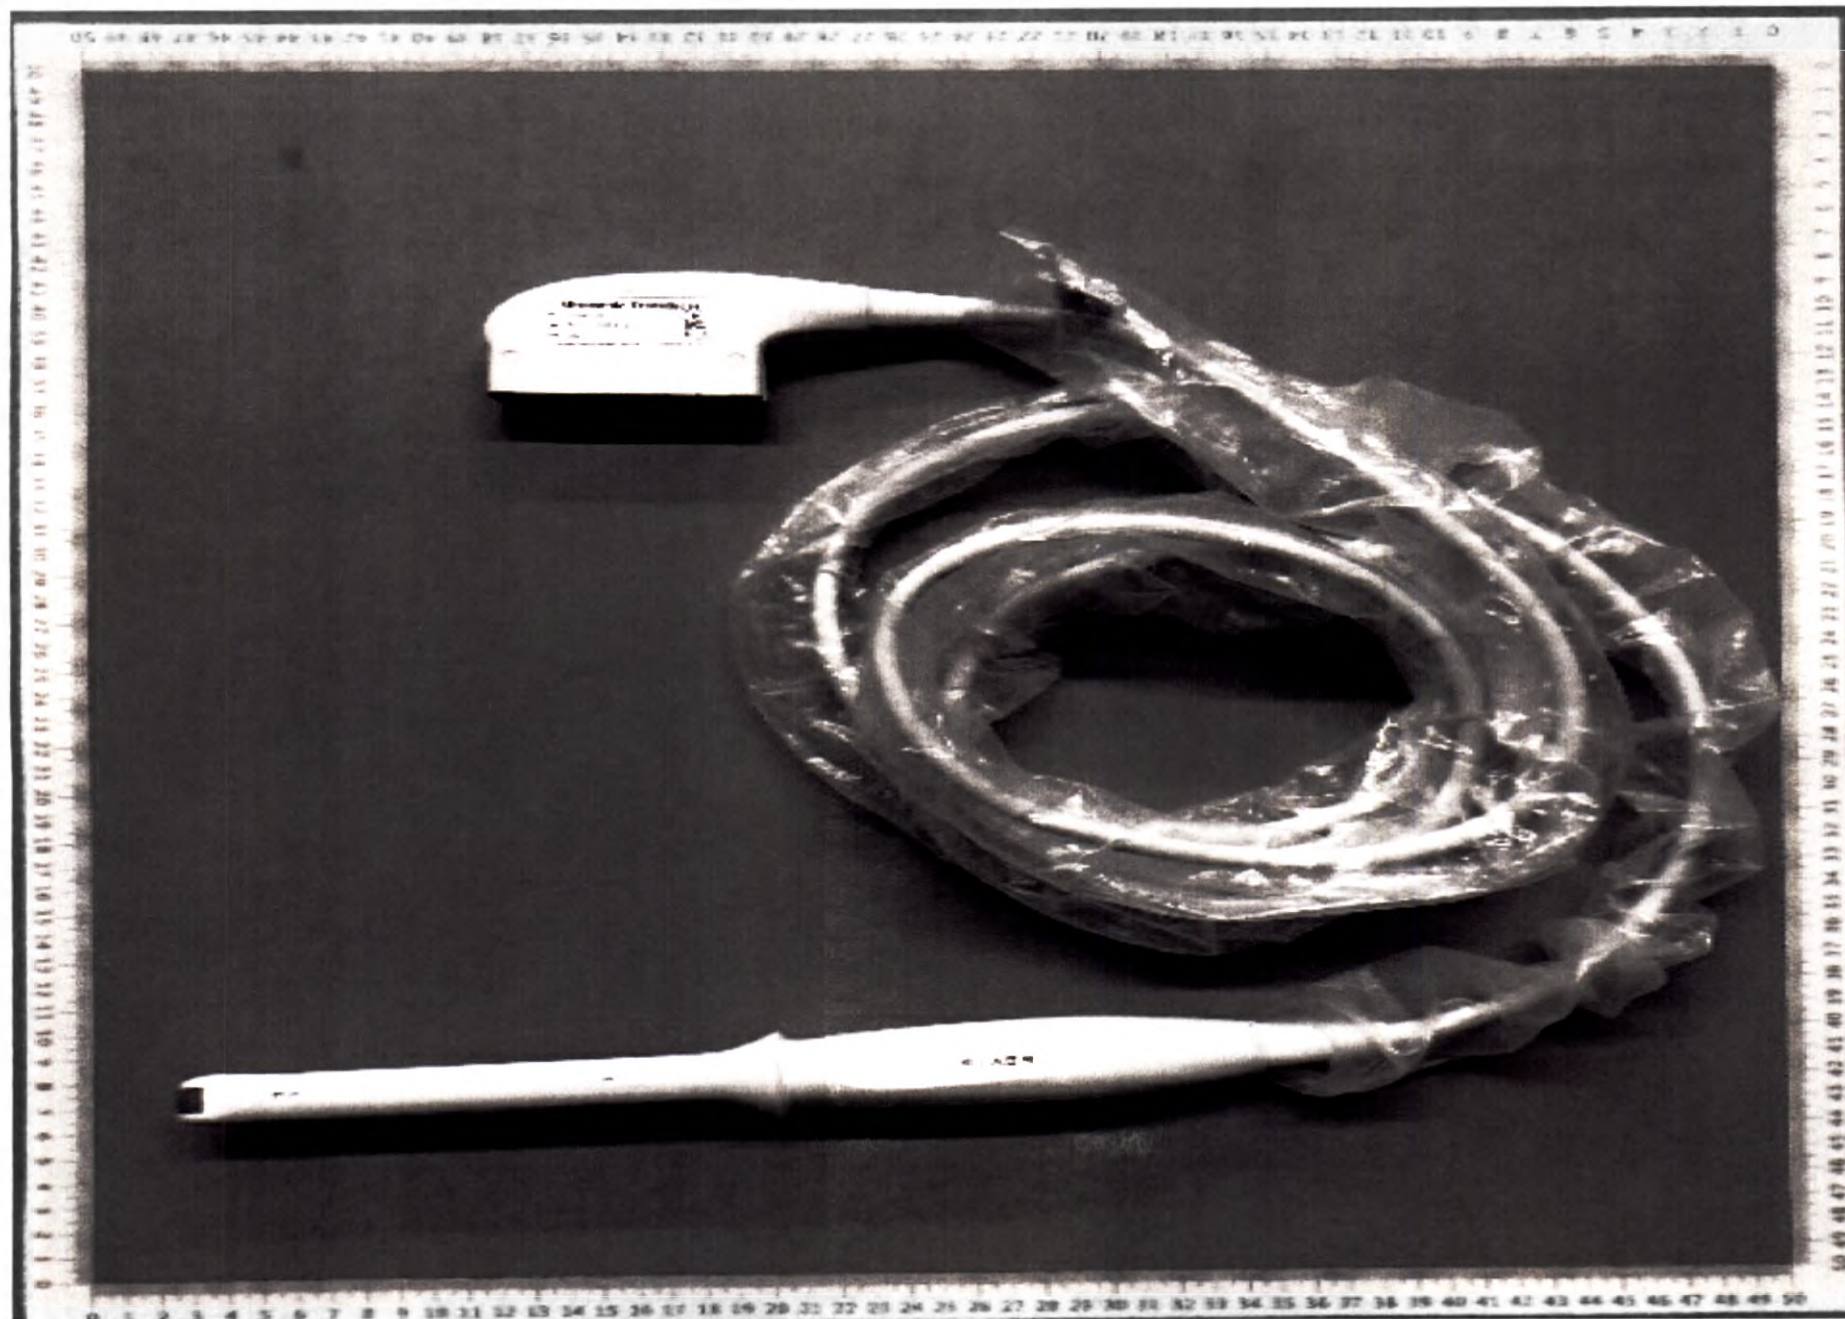


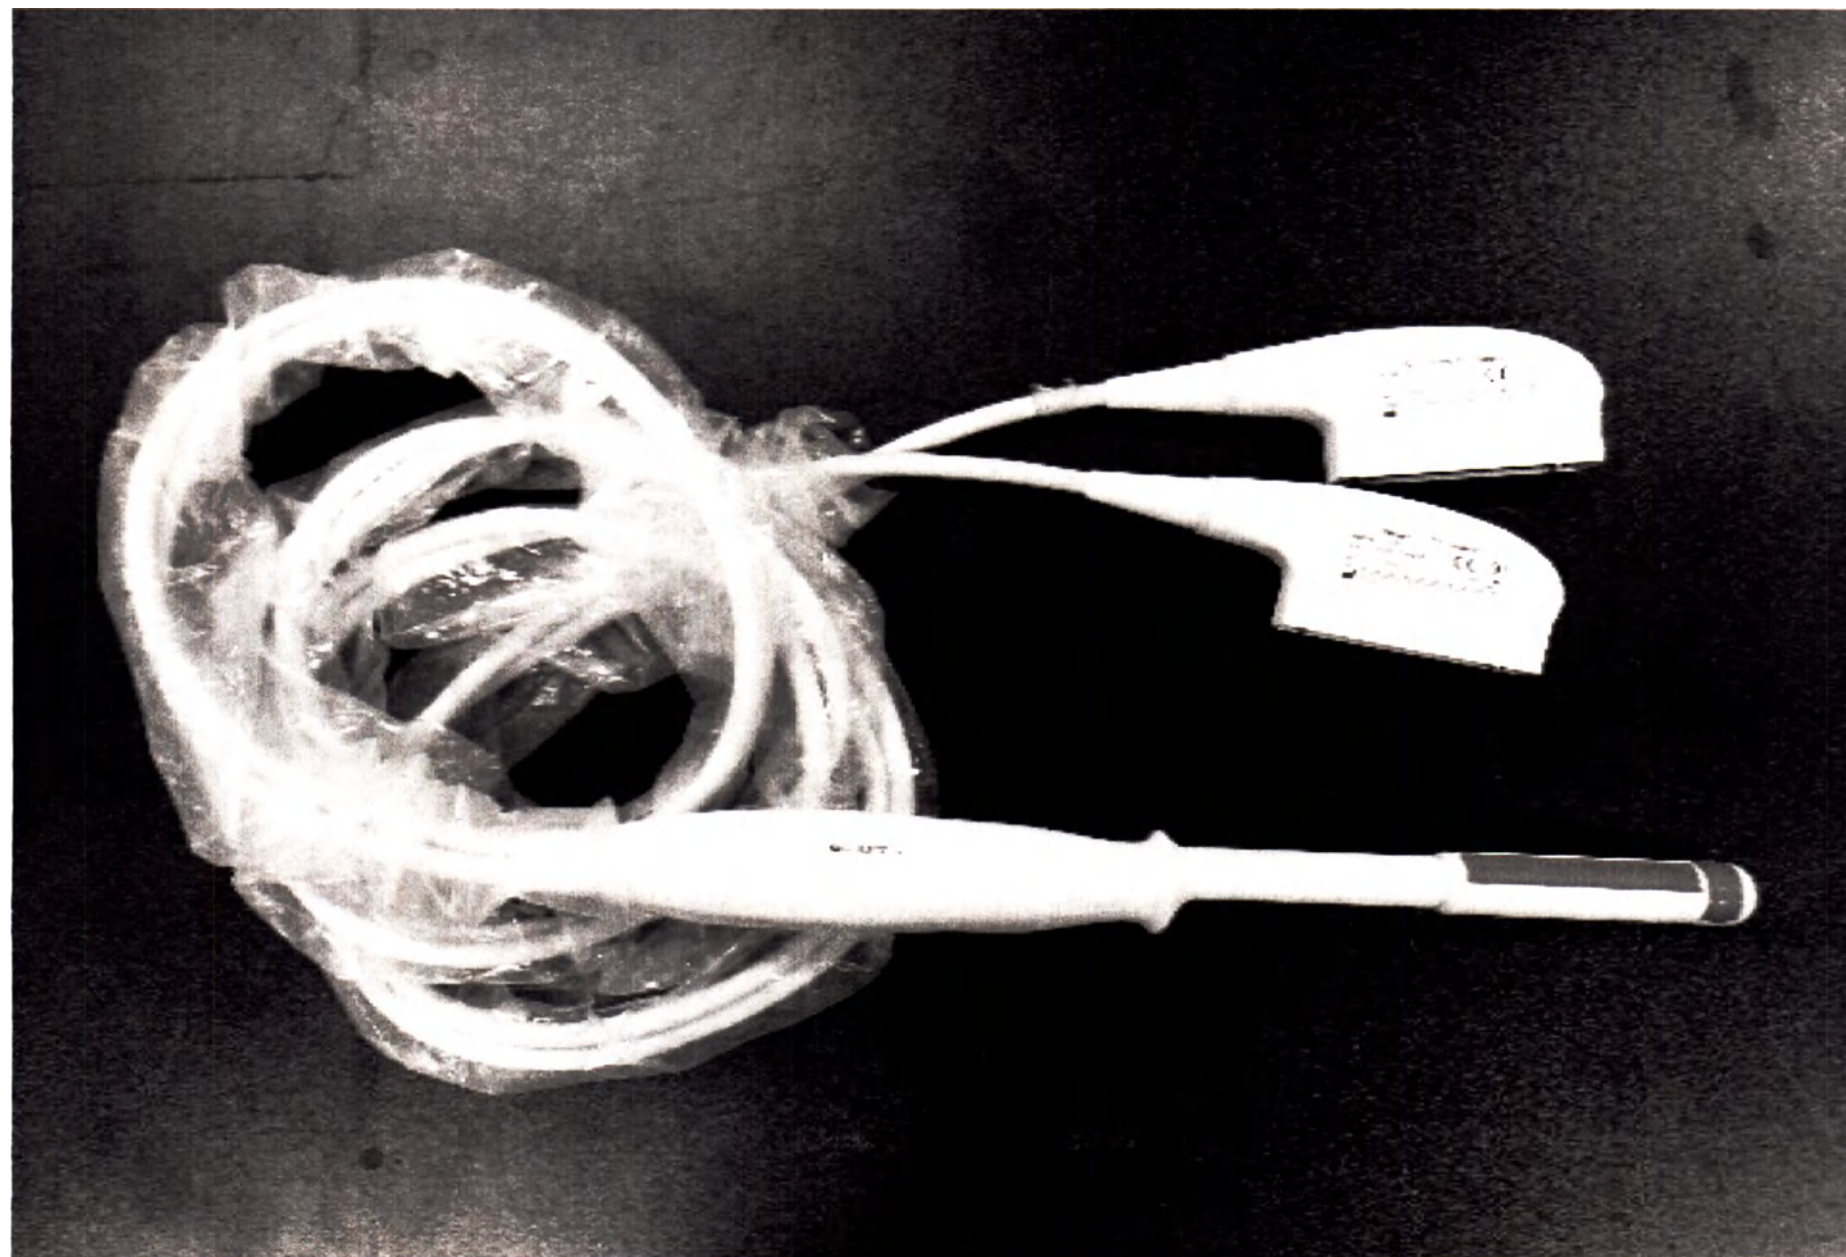

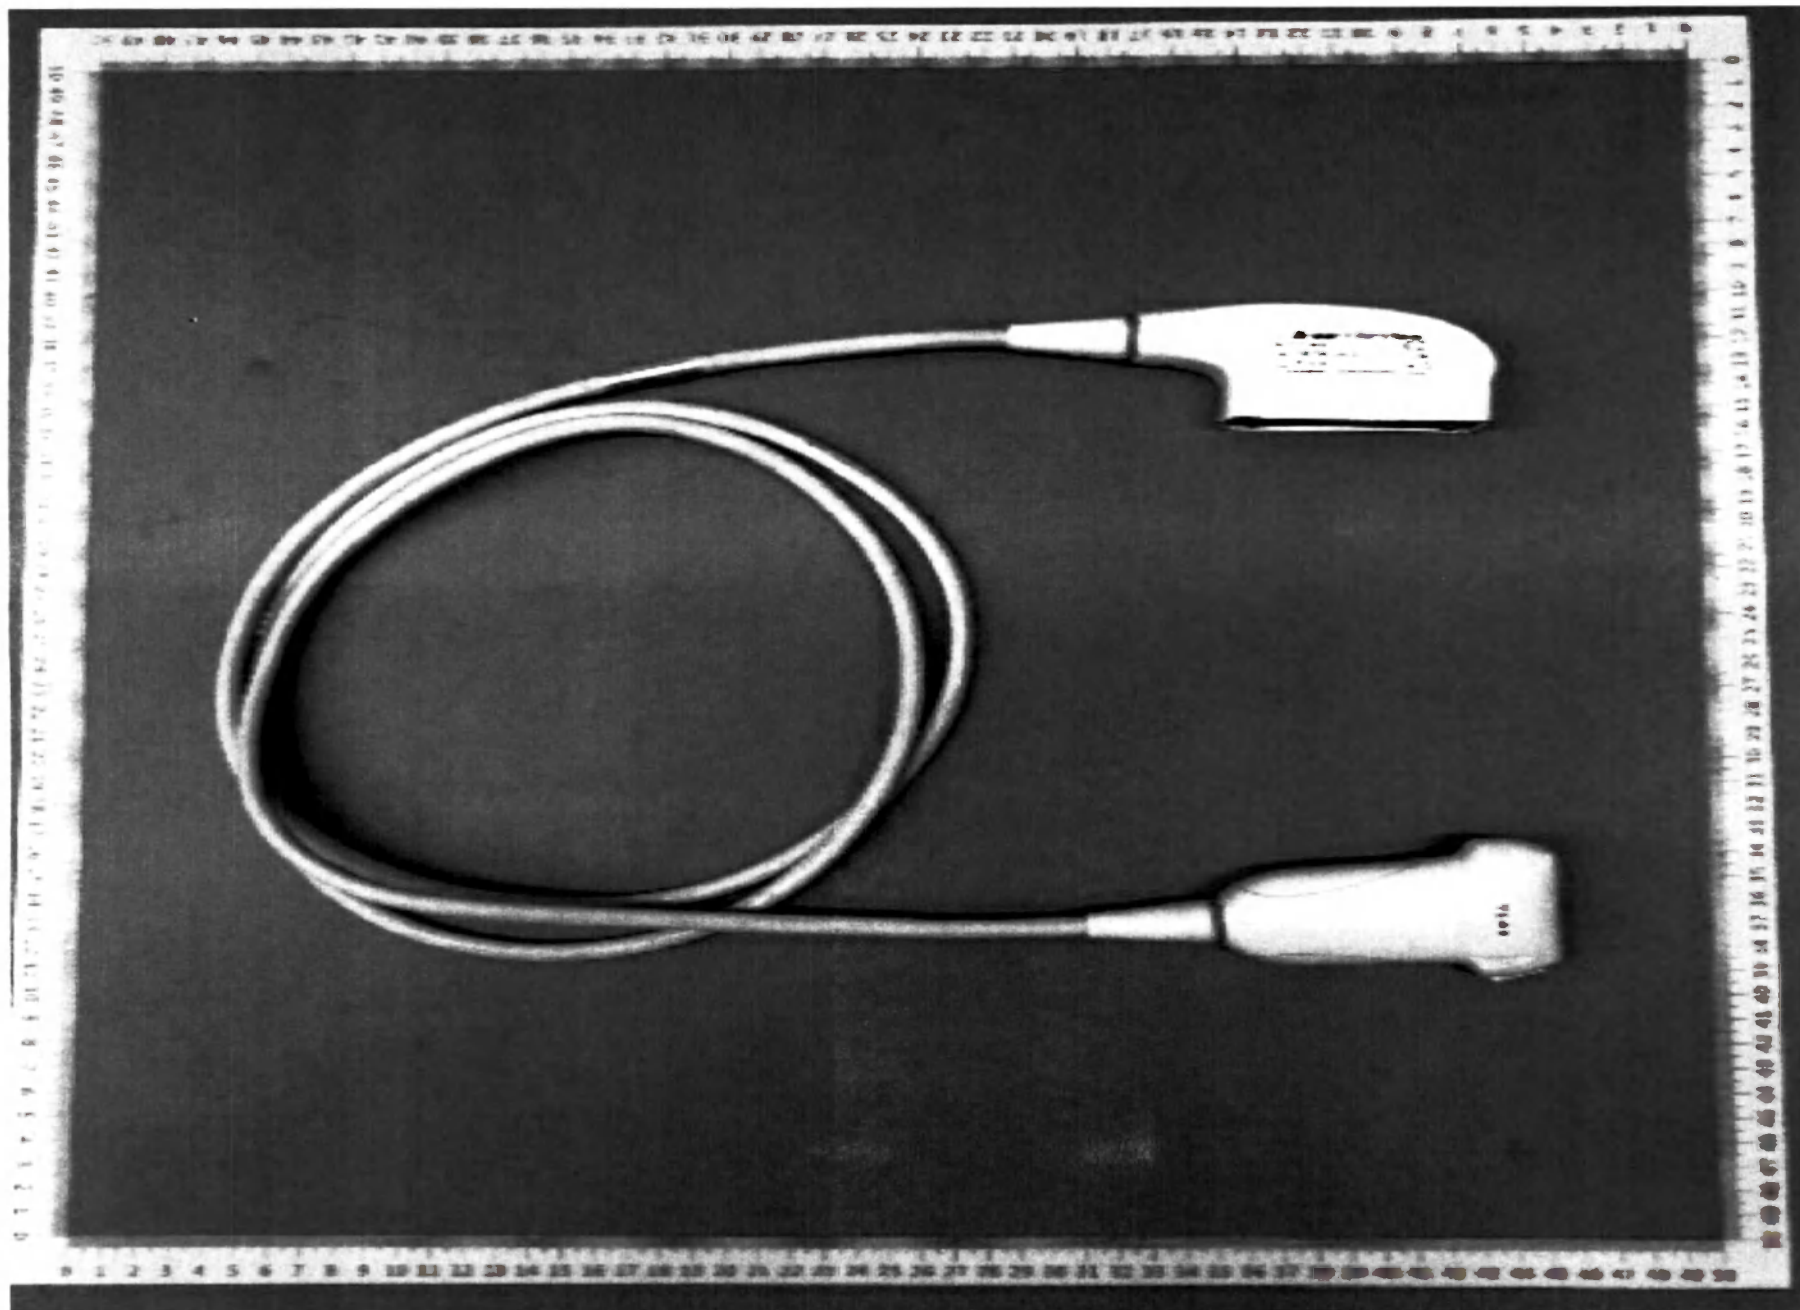

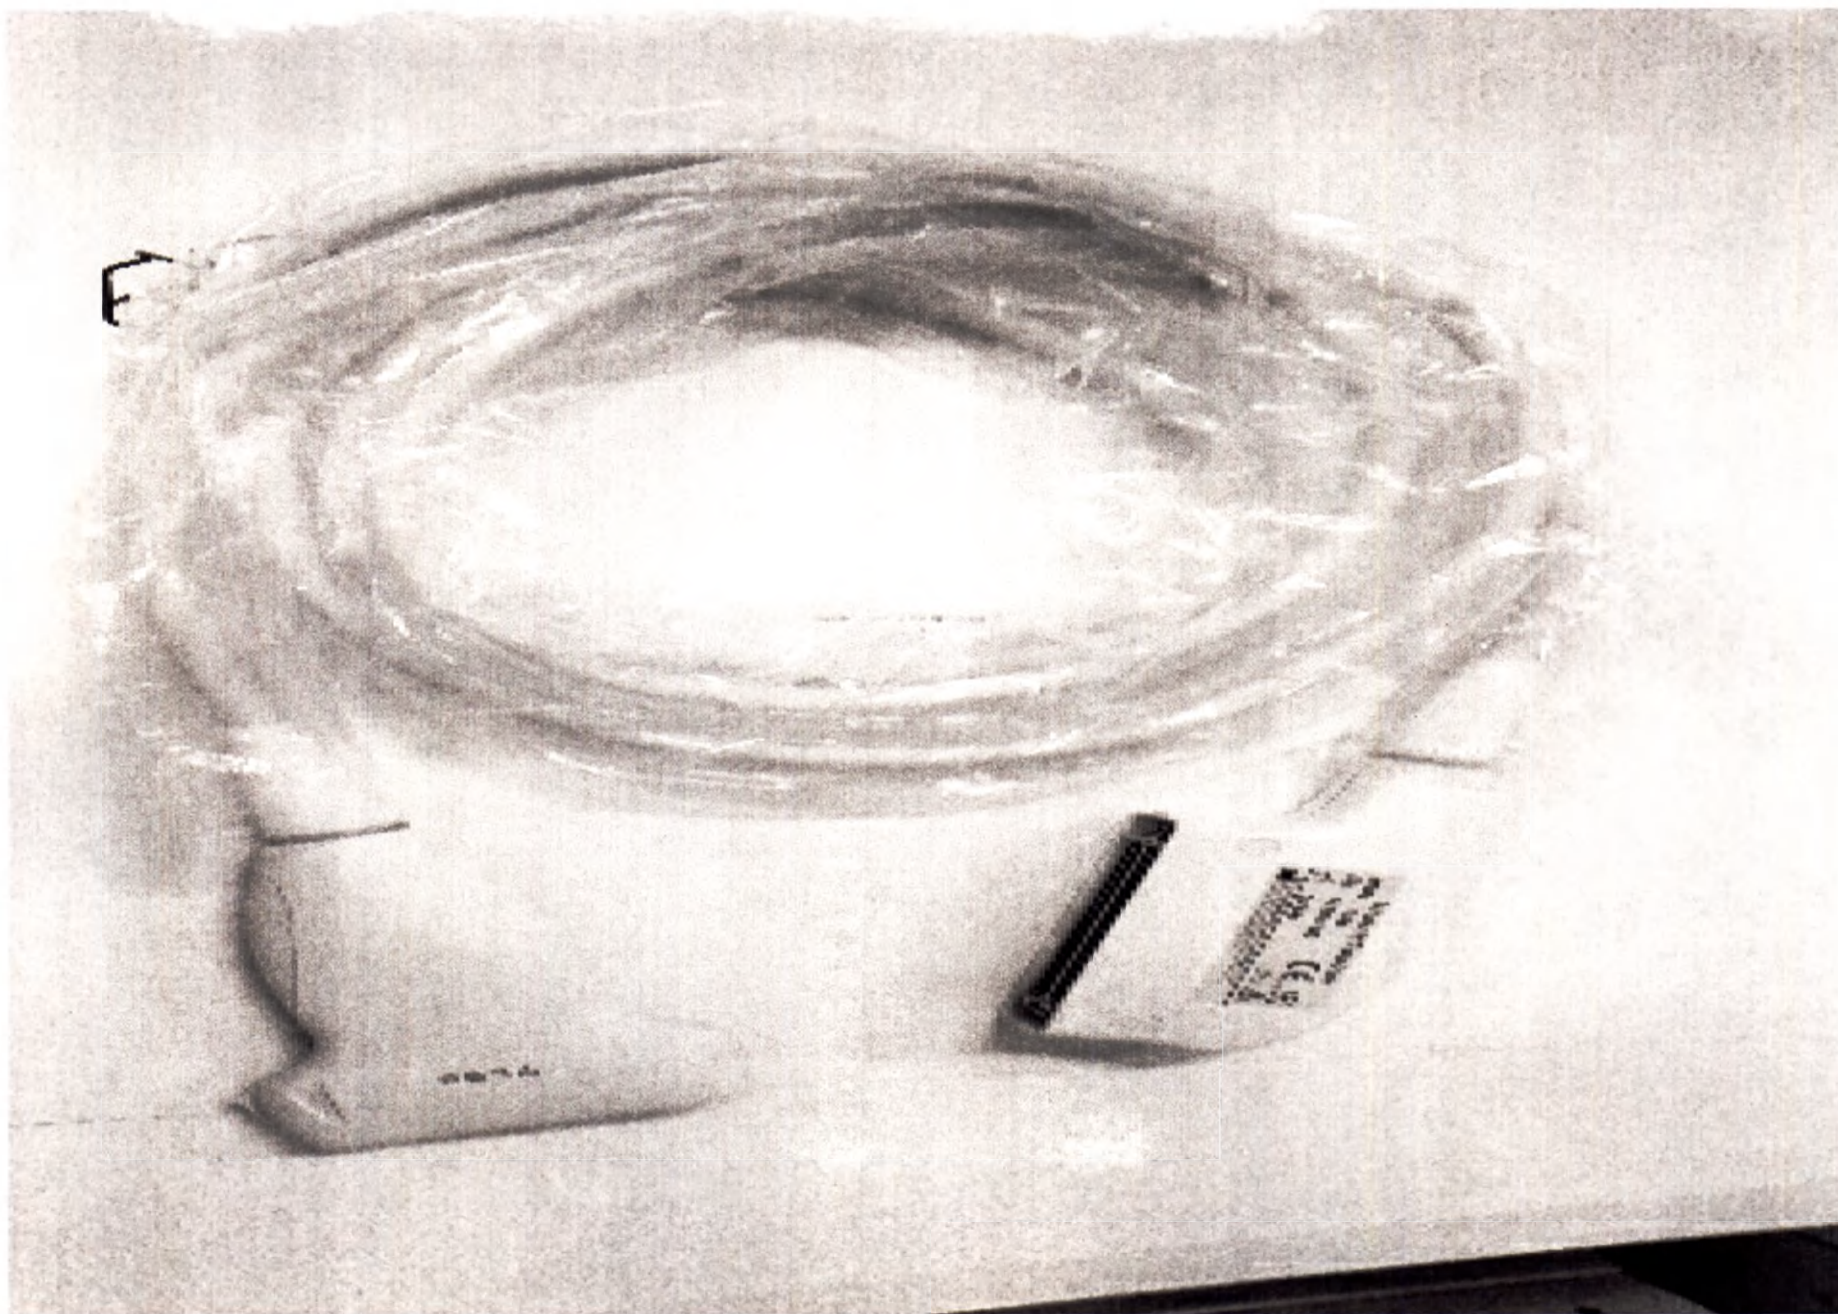


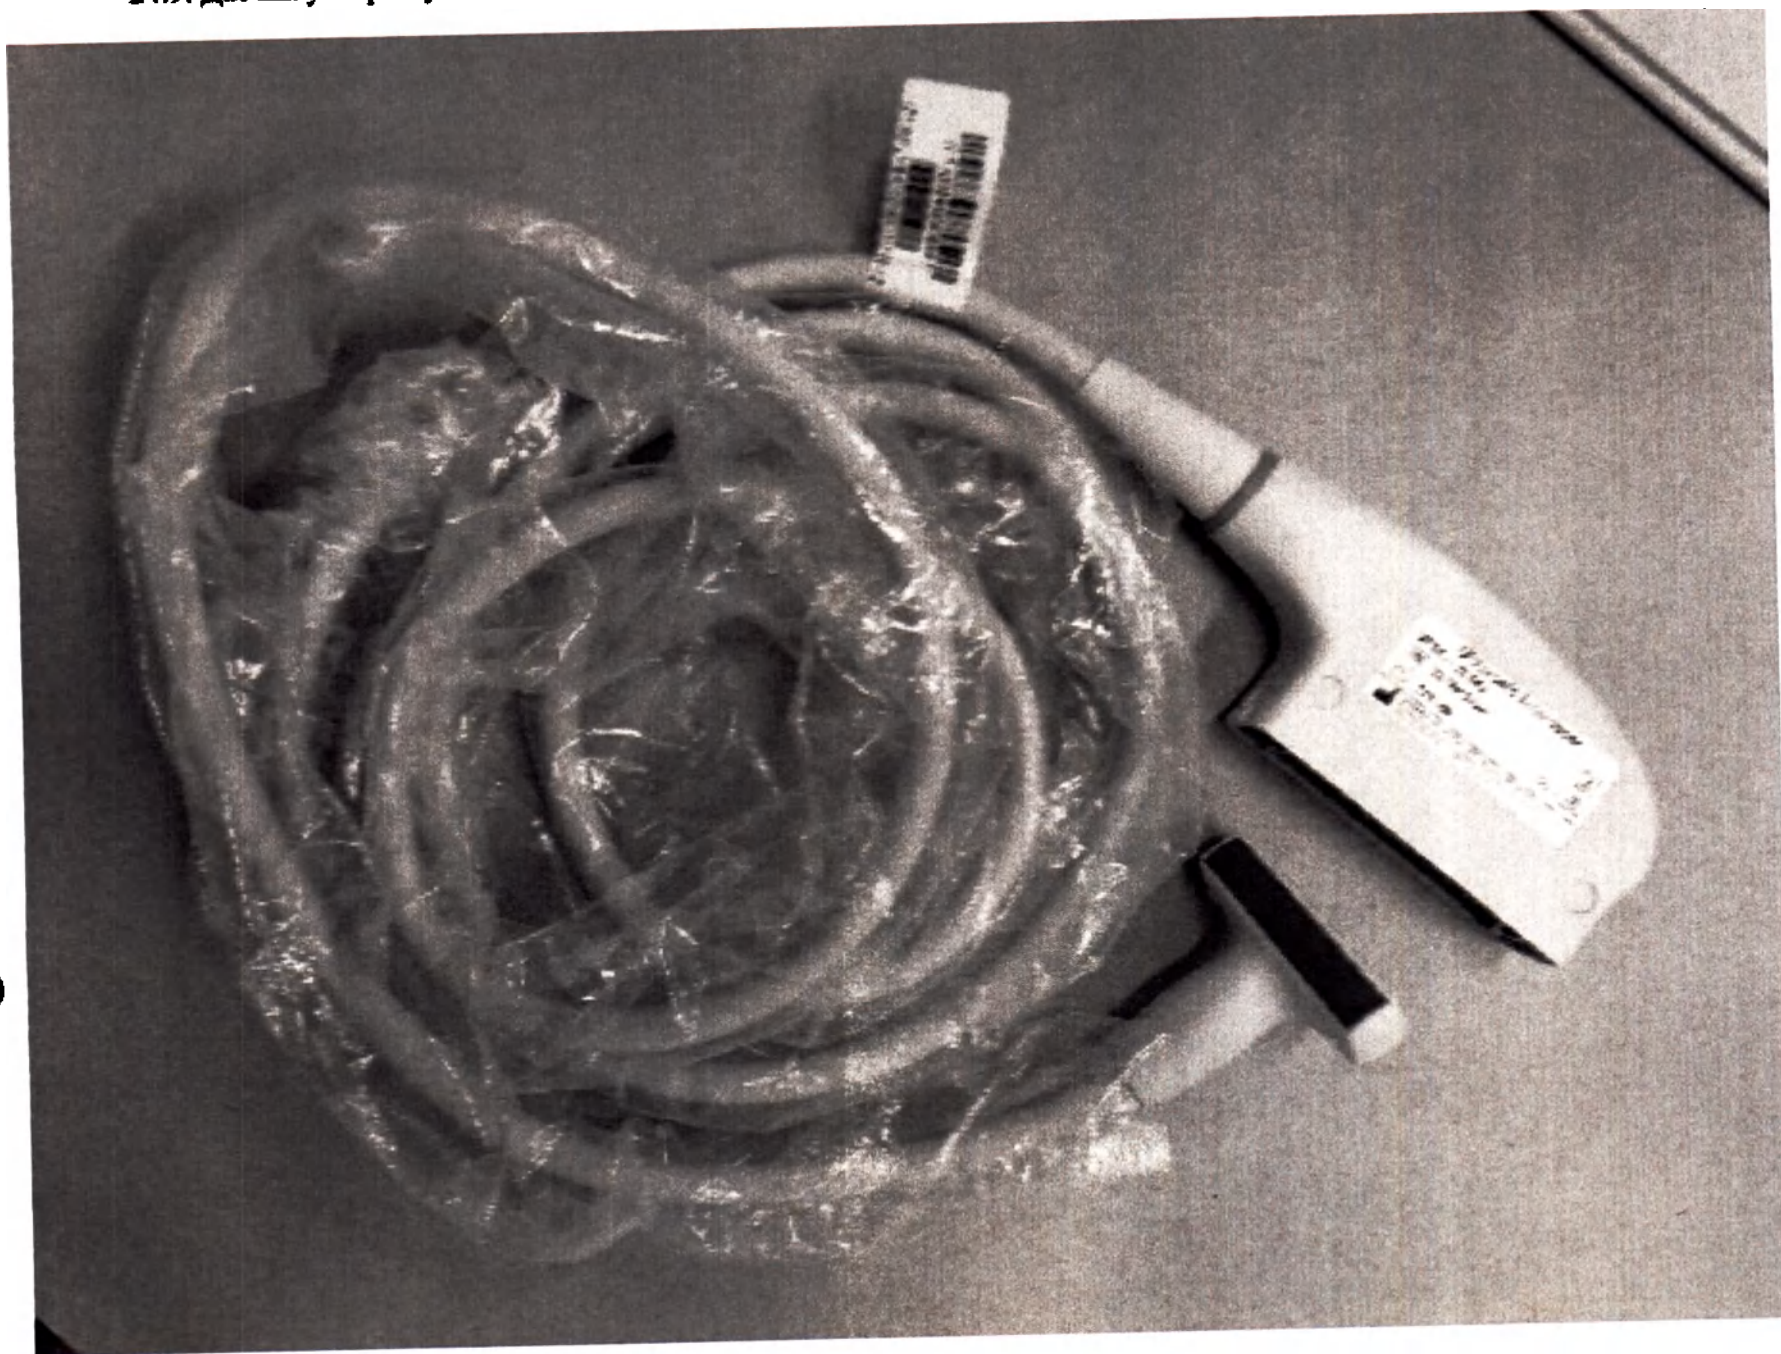

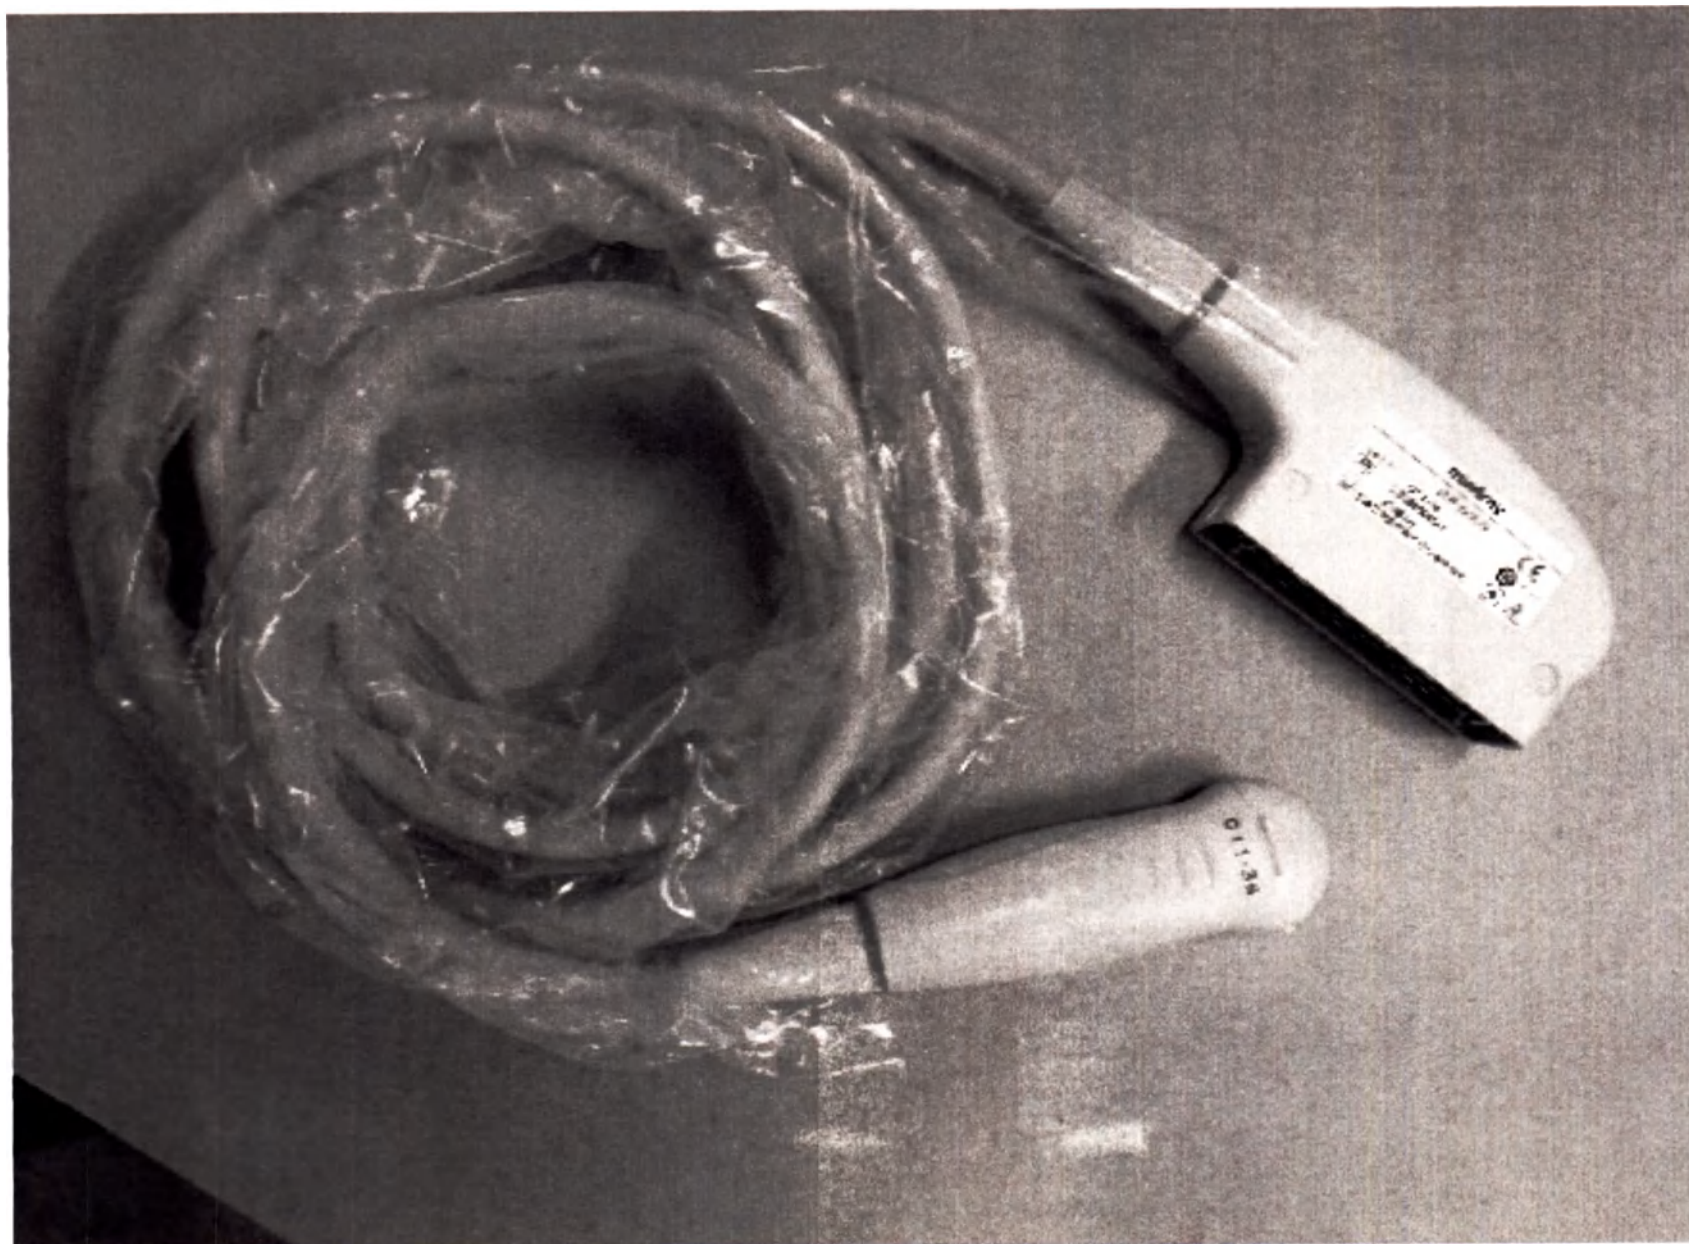





24.12. Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2s

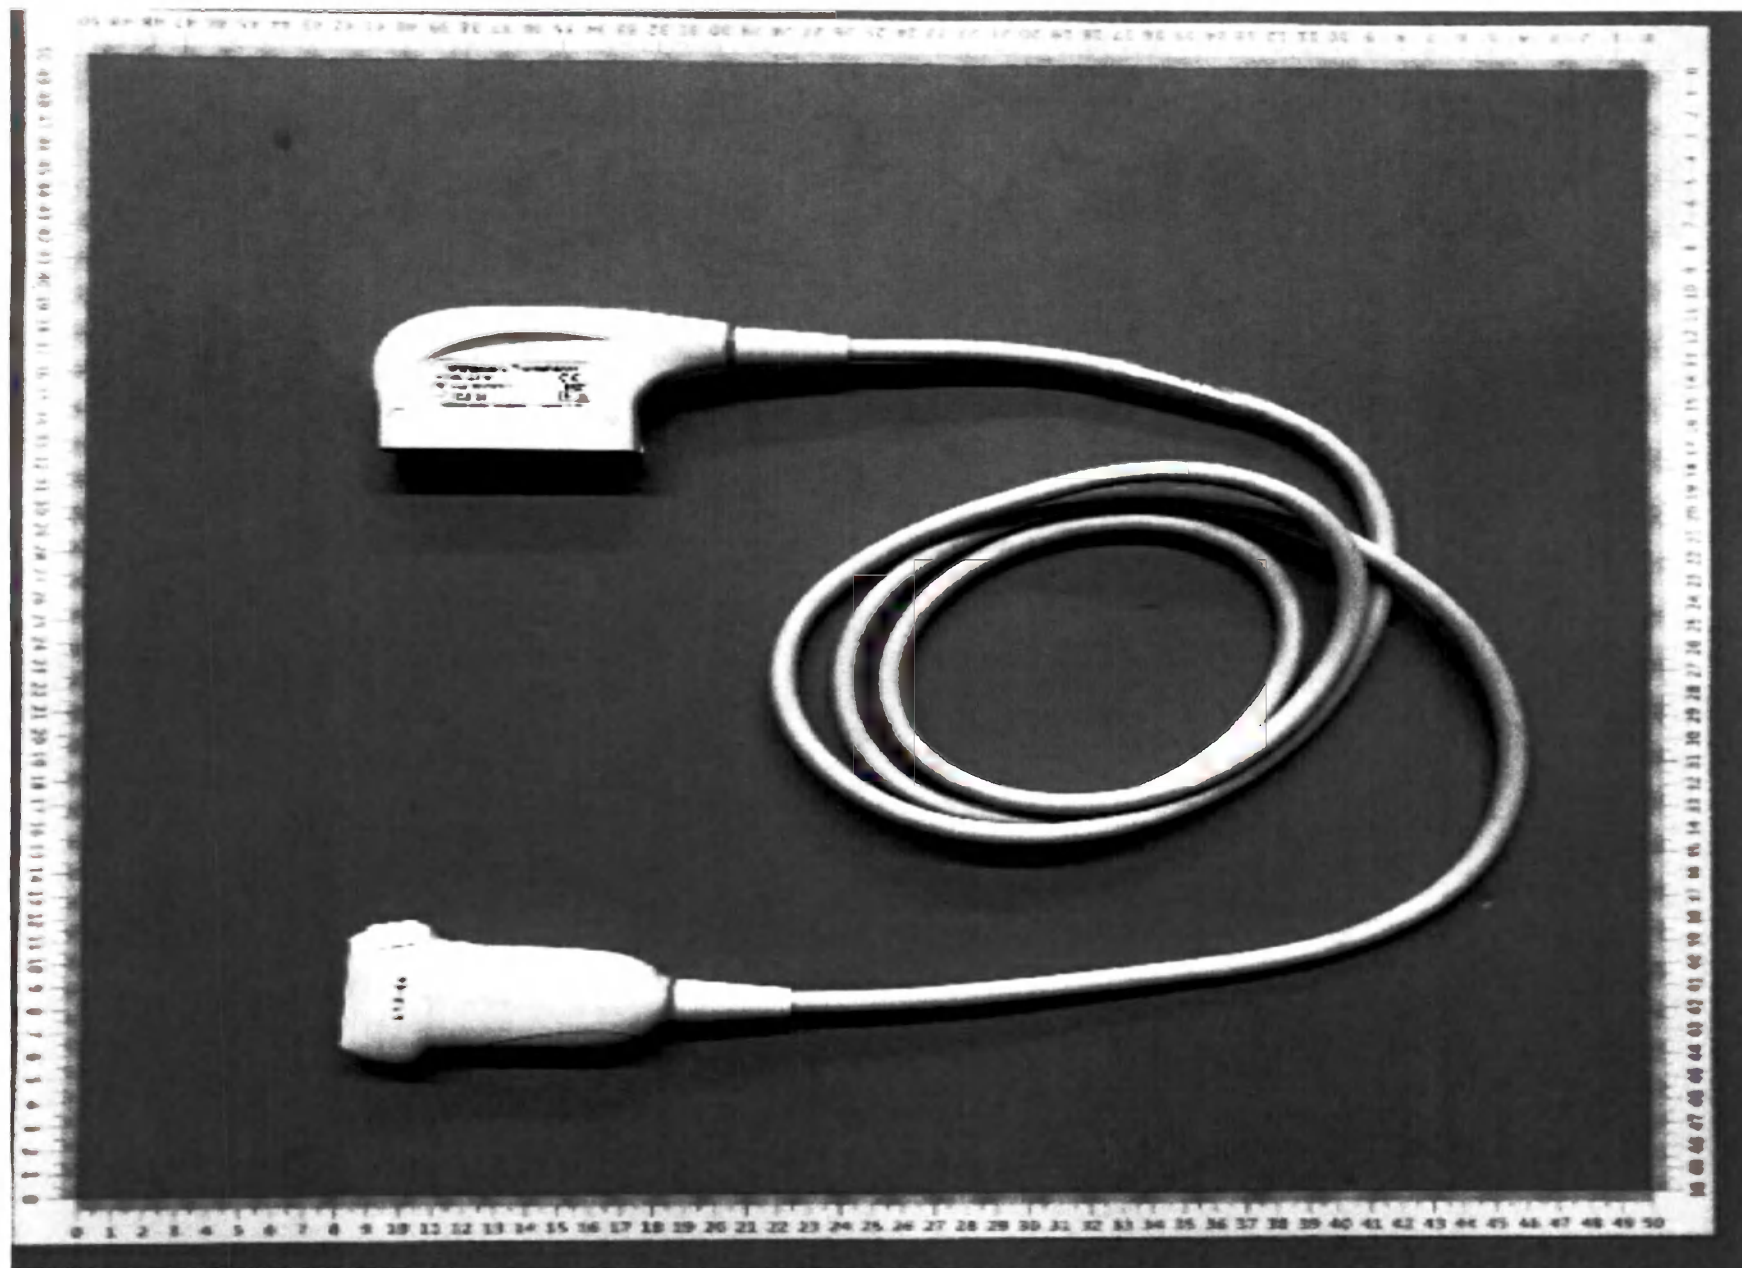



24.15. датчик ультразвуковой линейный L12-4s

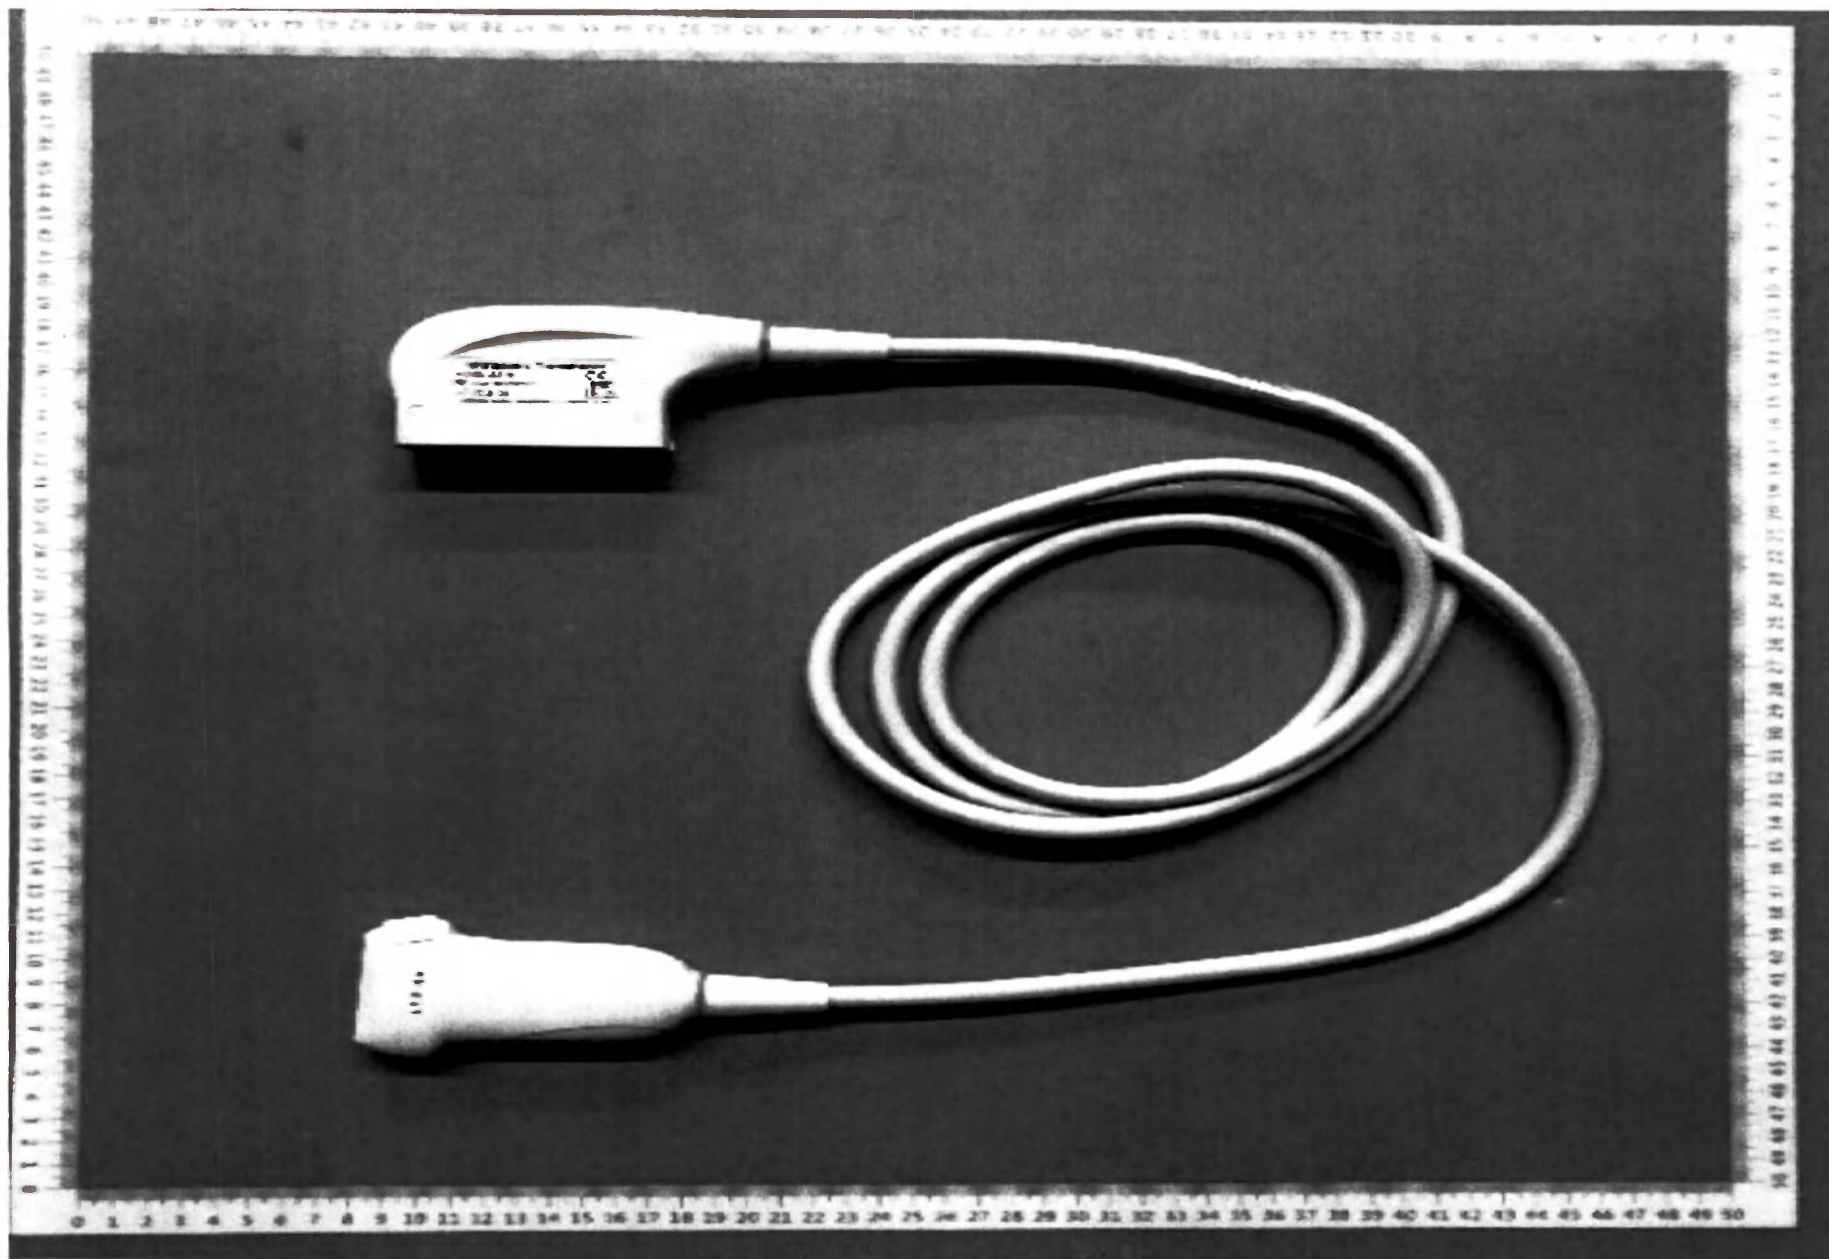



24.14. Датчик ультразвуковой линейный L14-6Ns

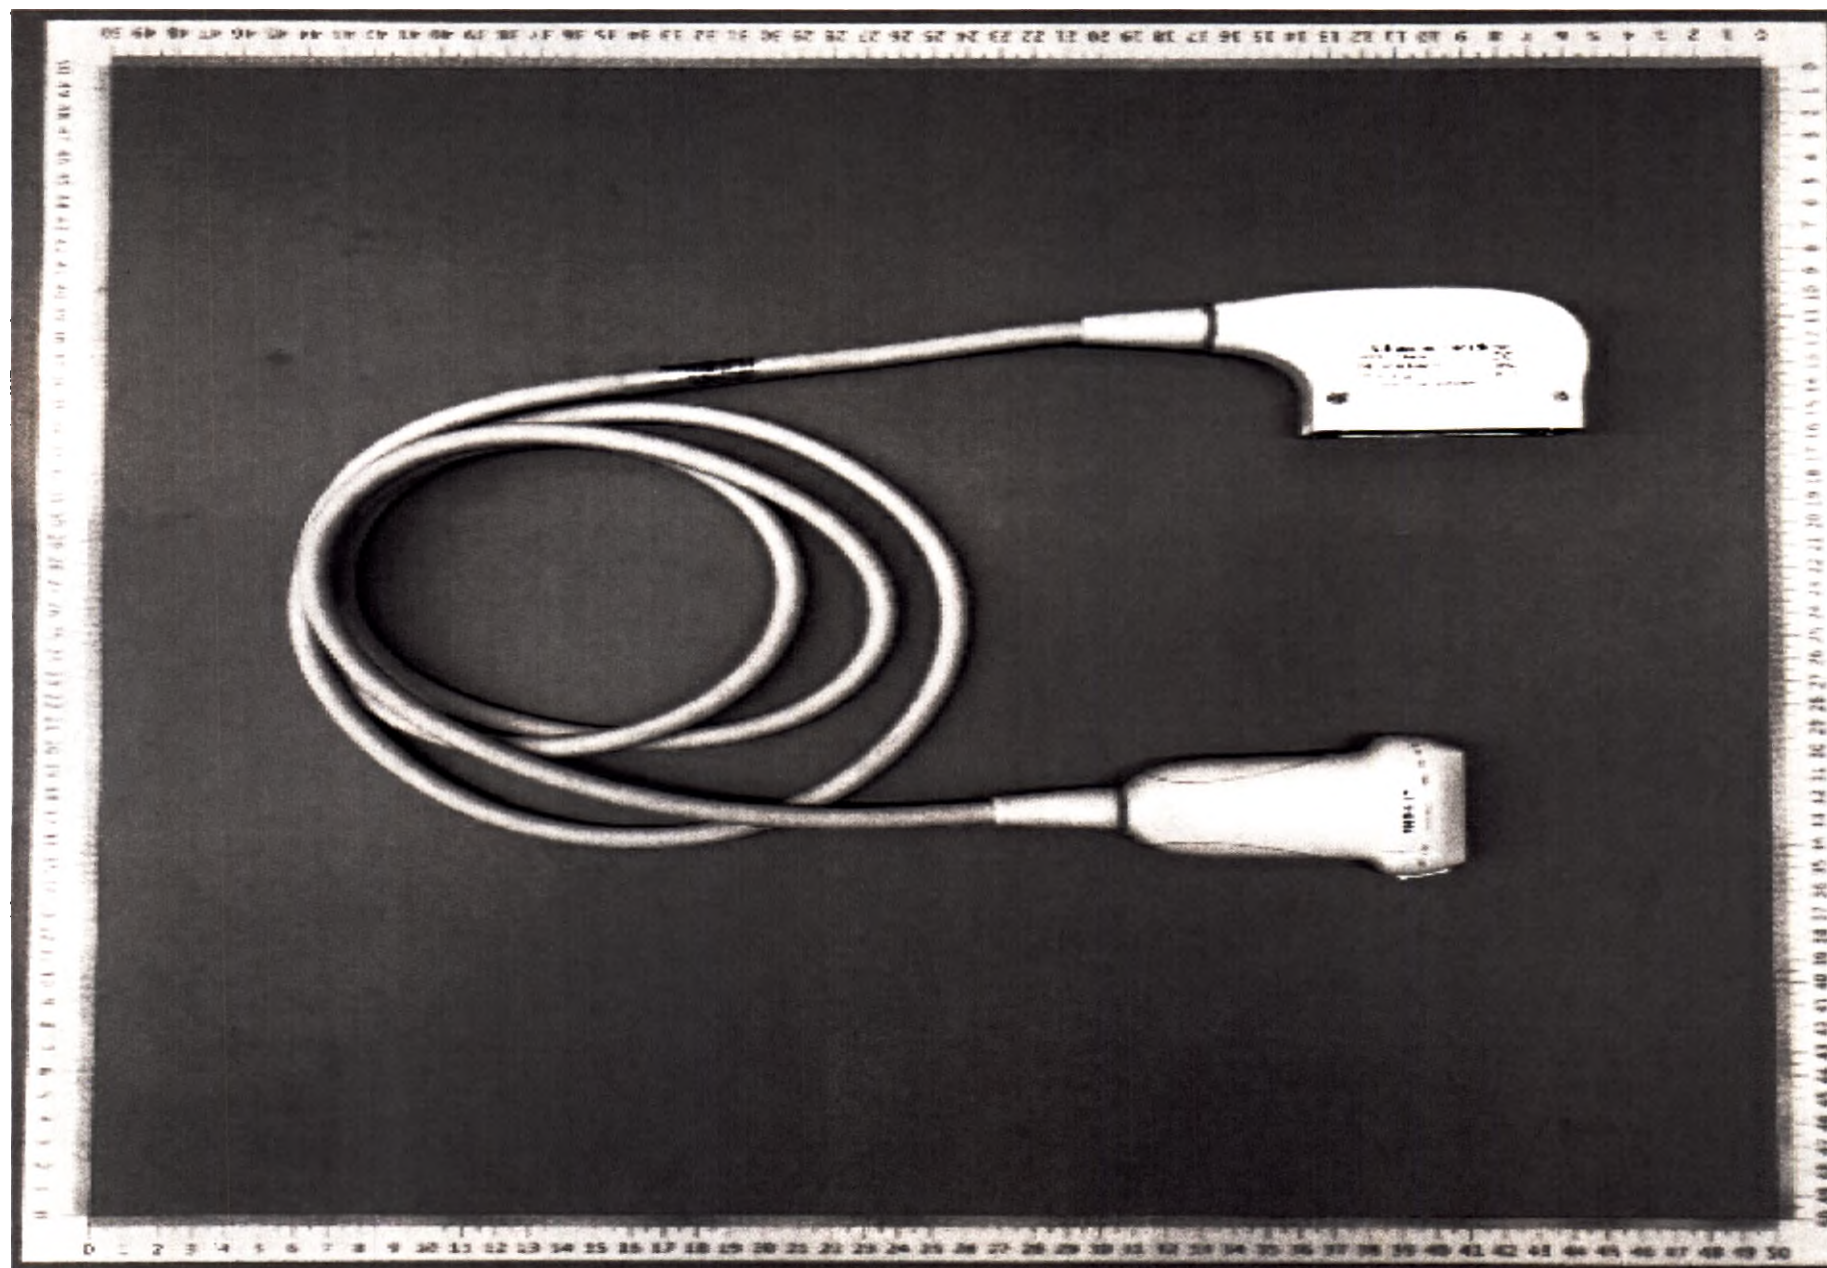

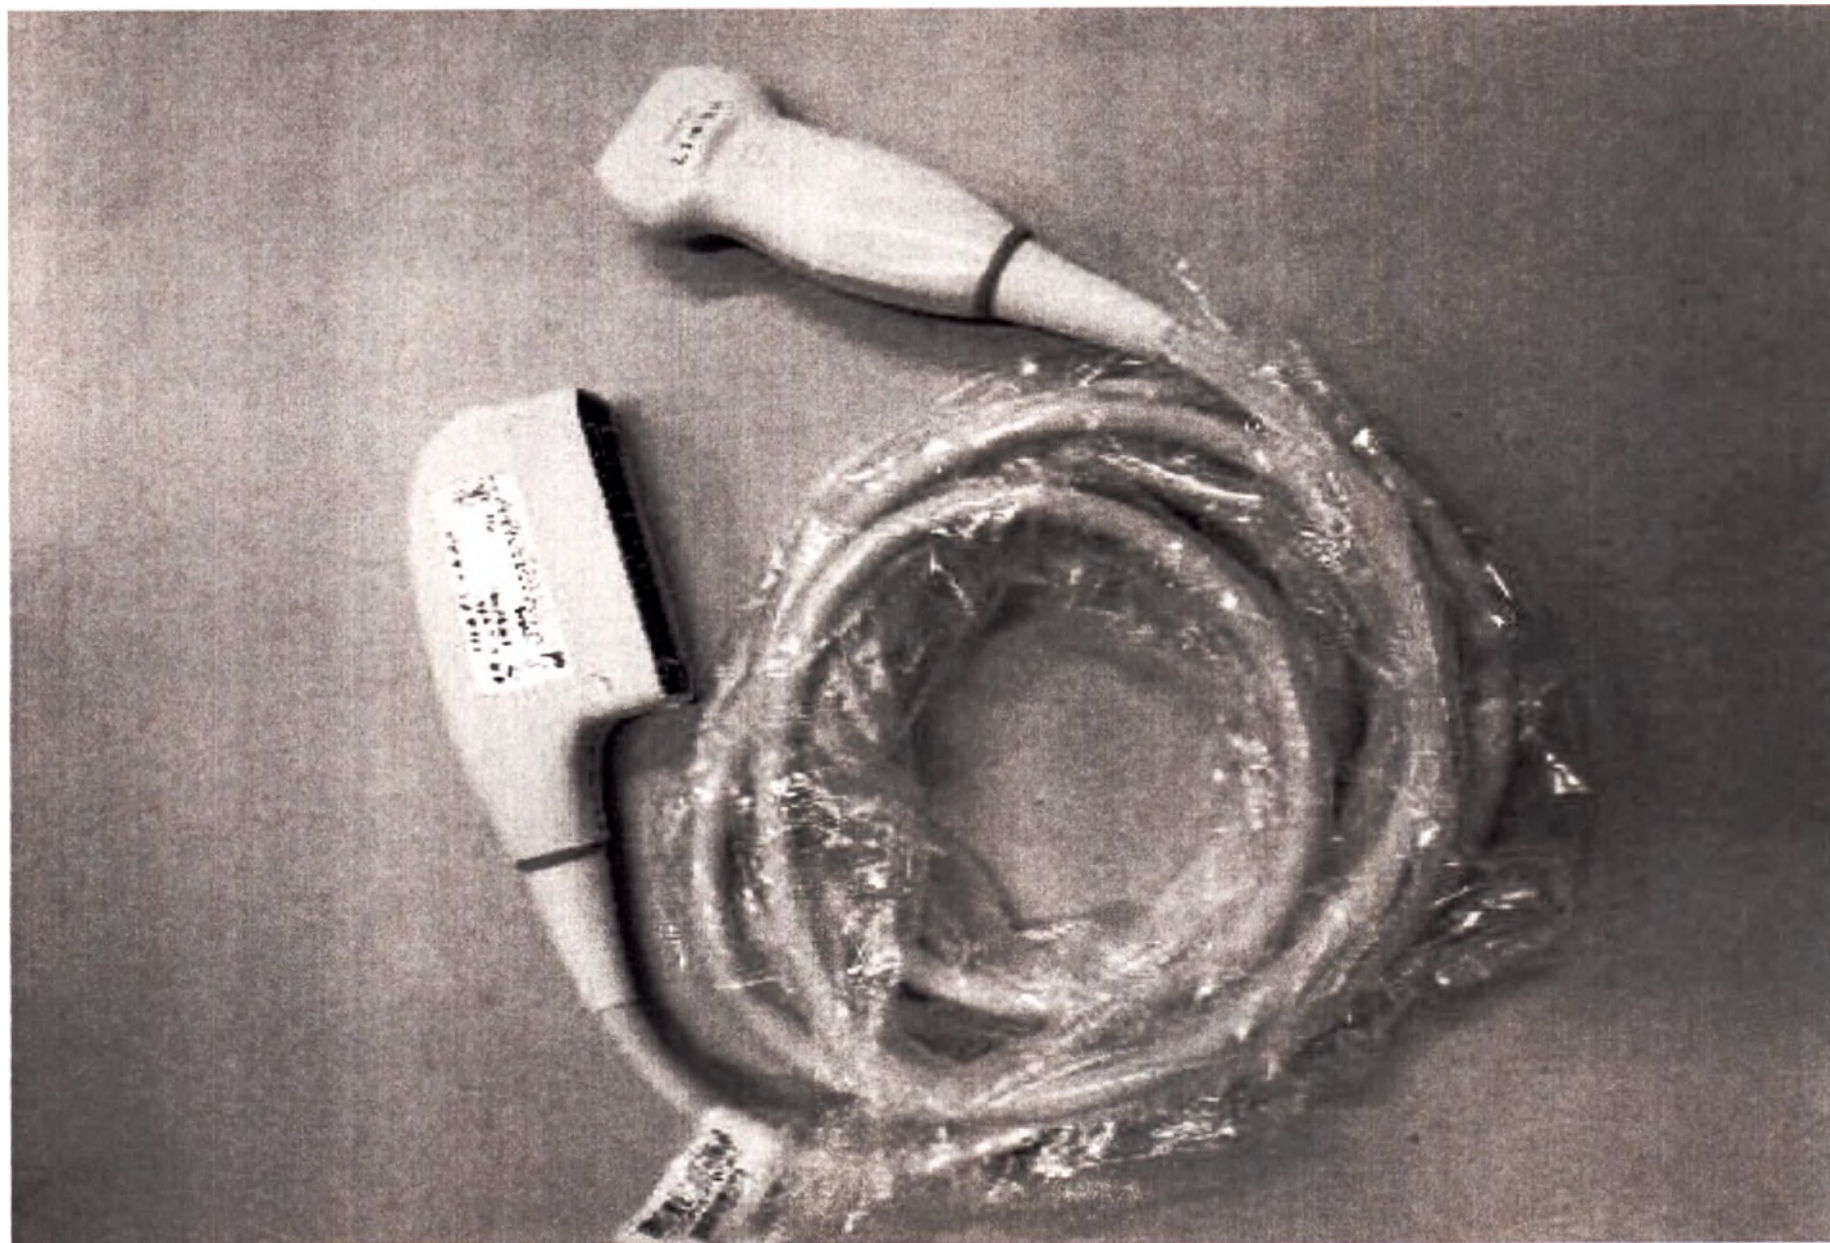


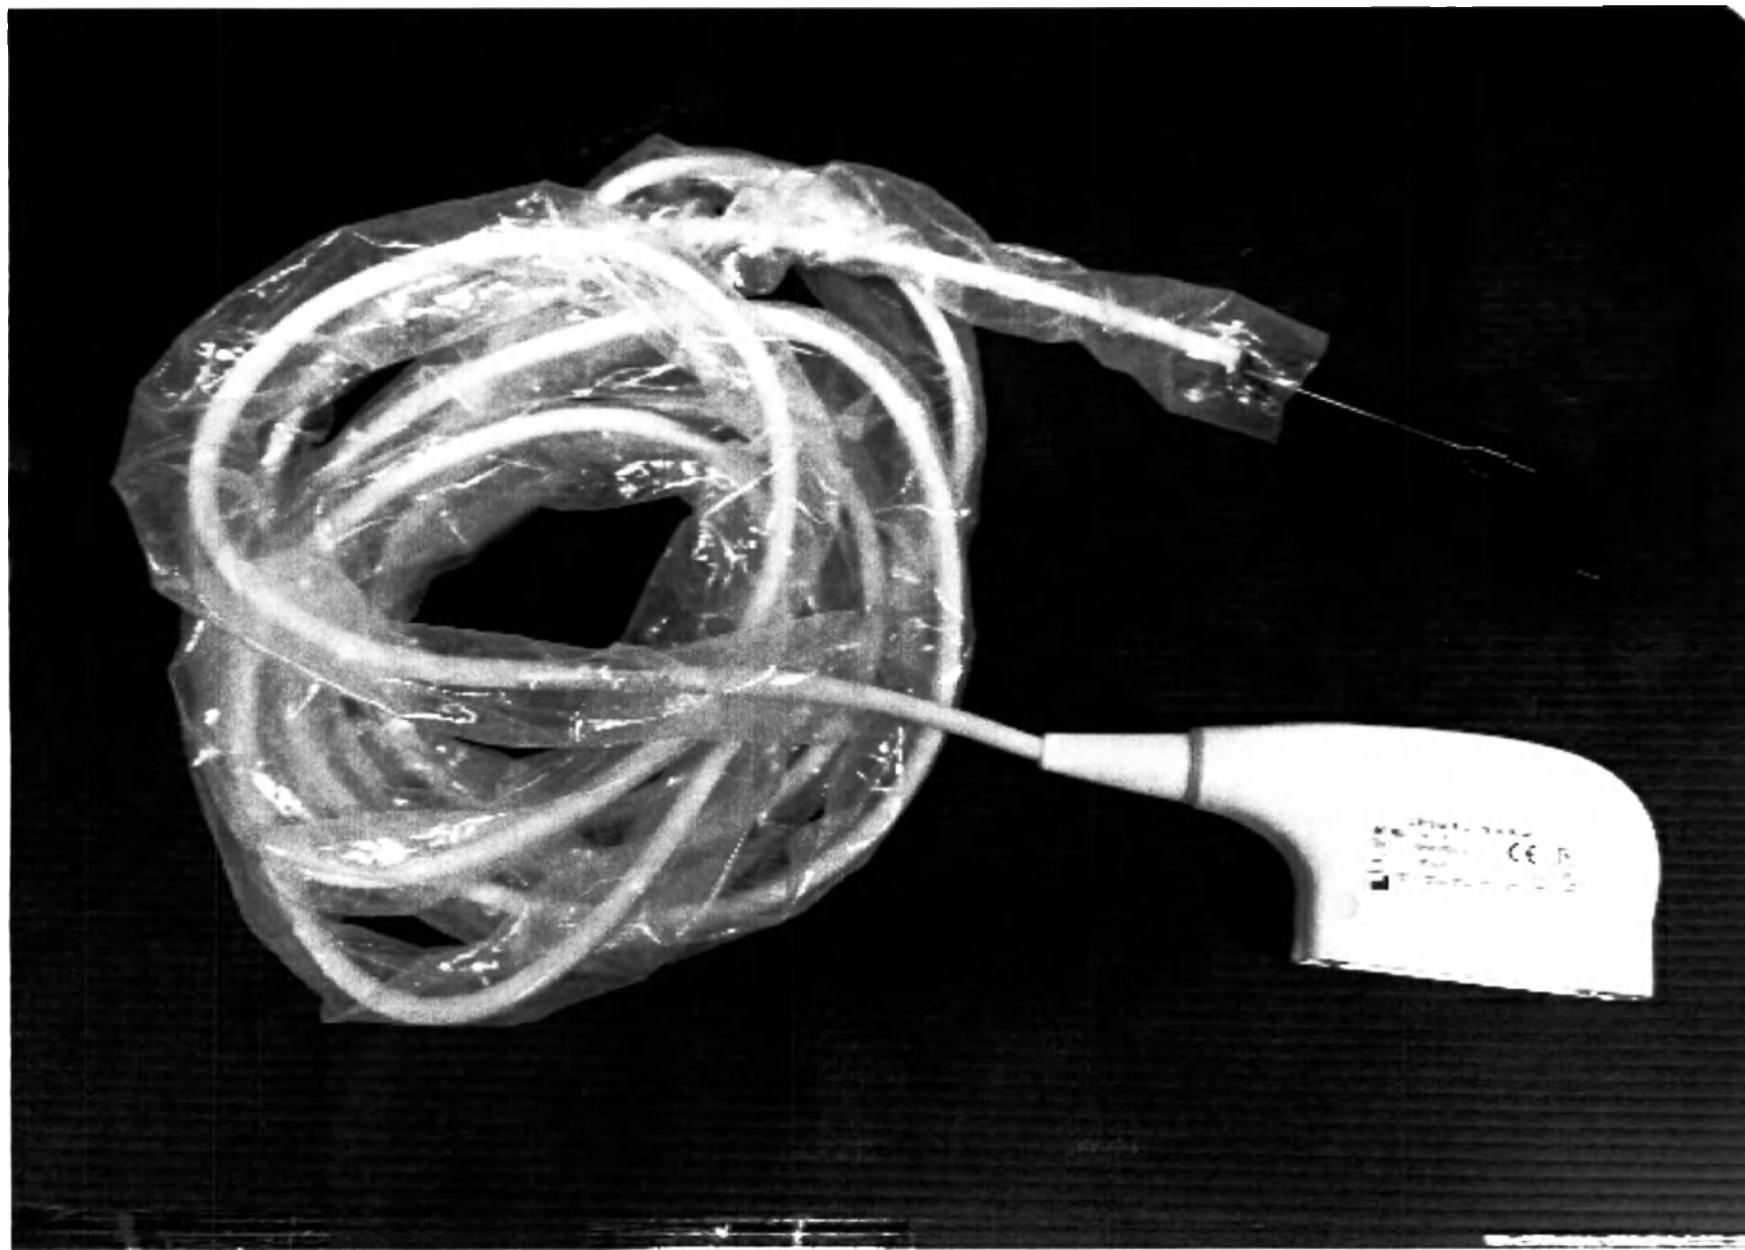

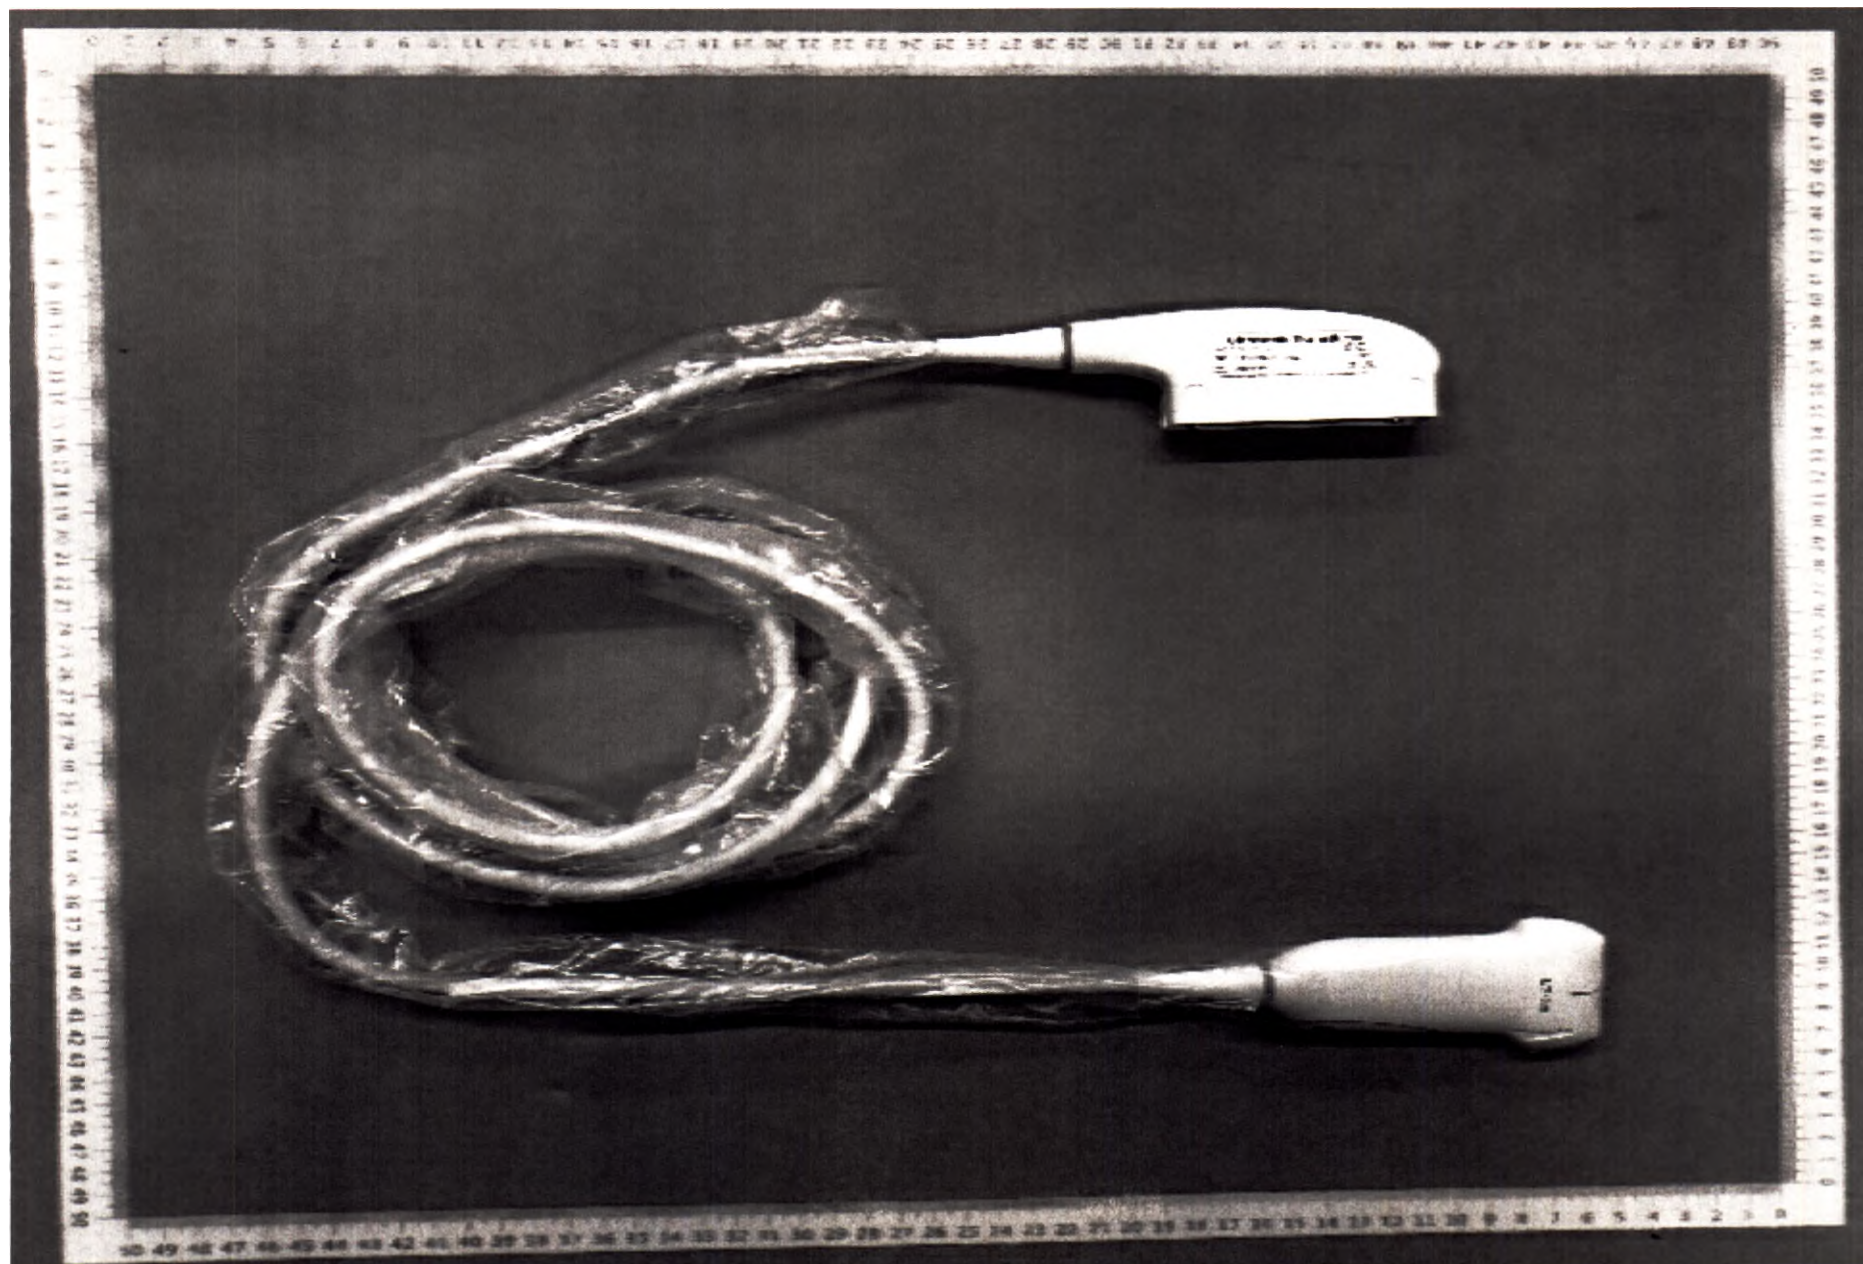

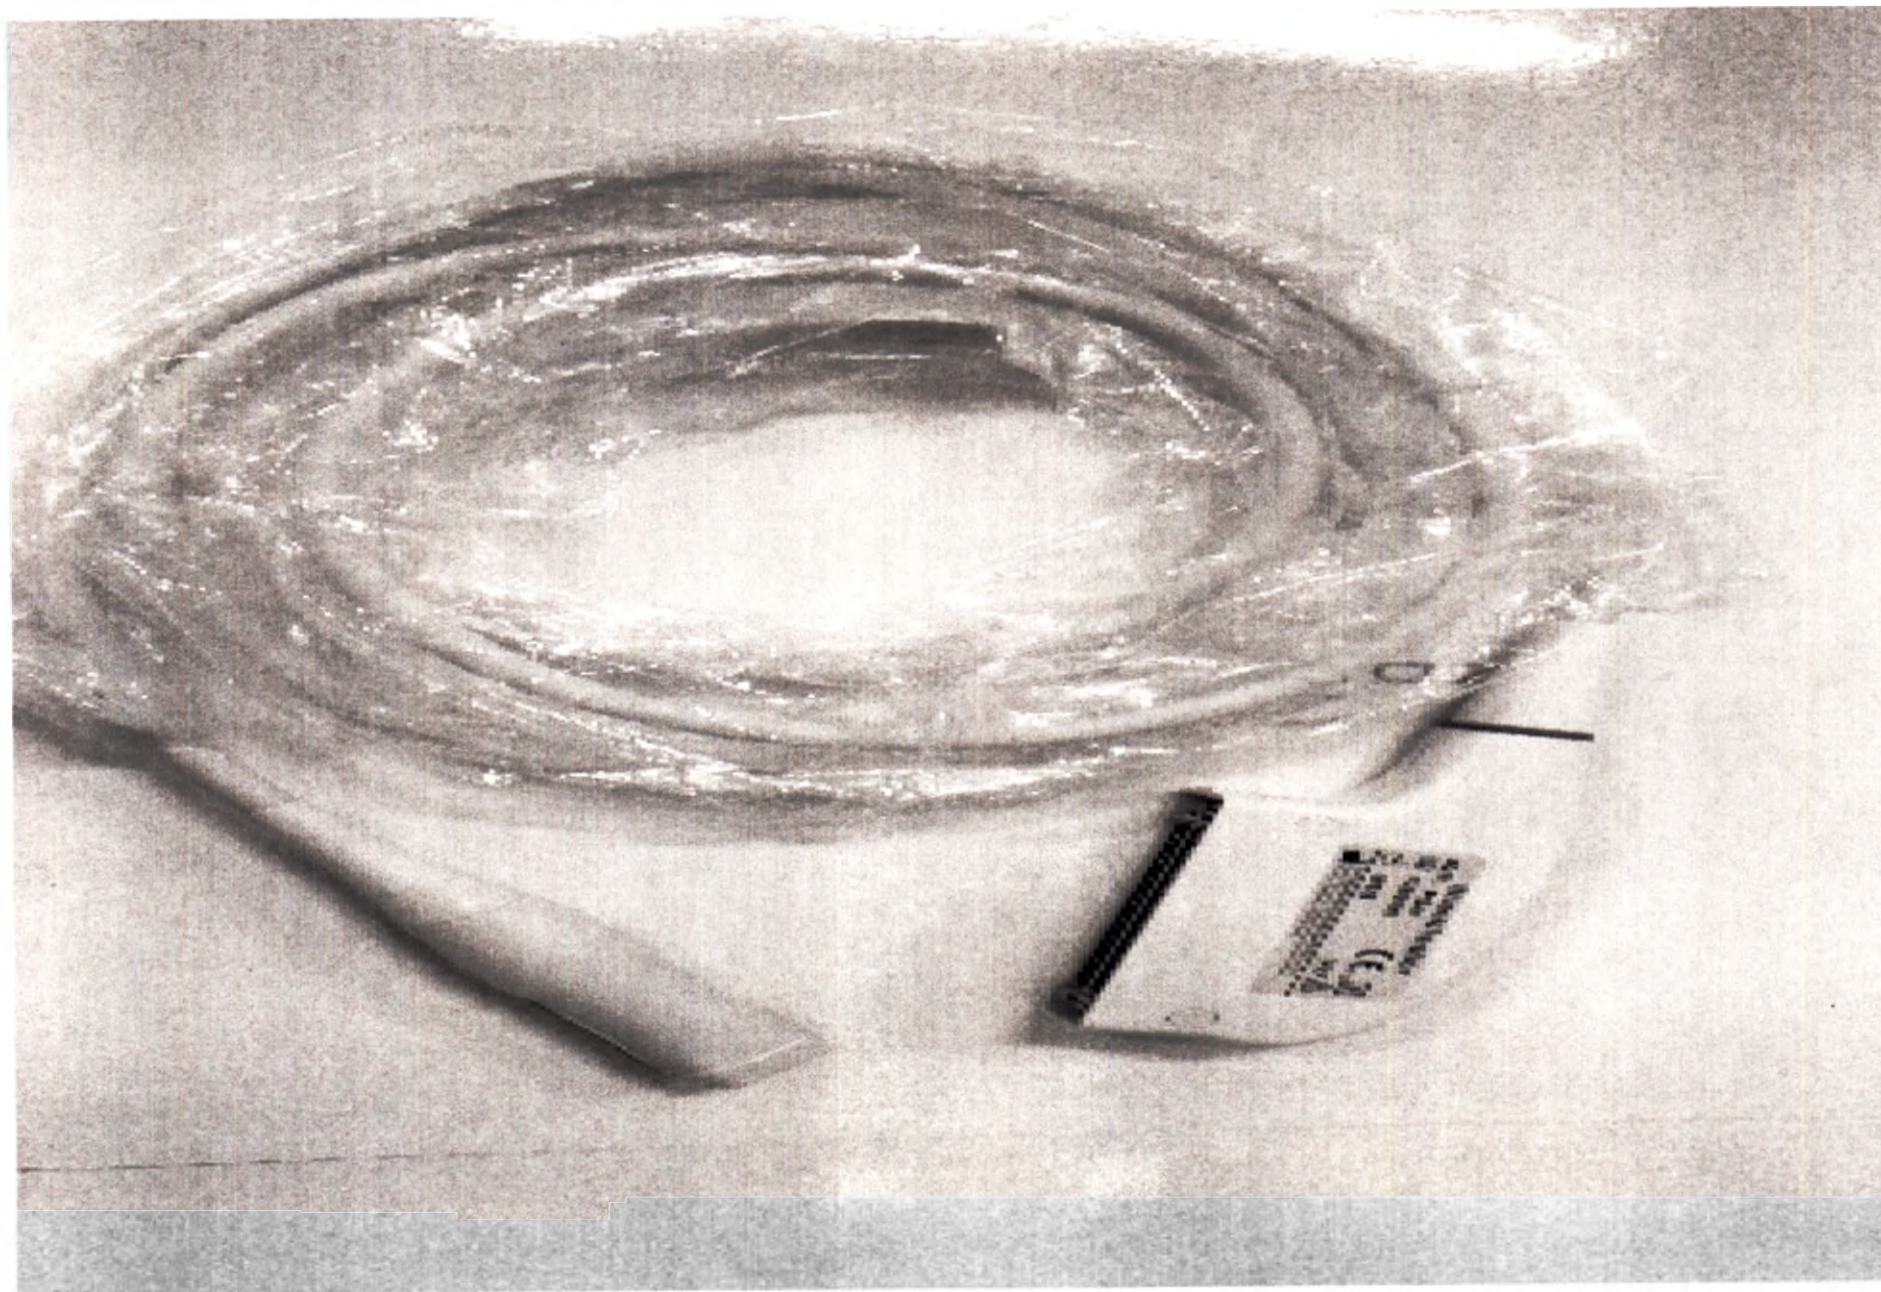





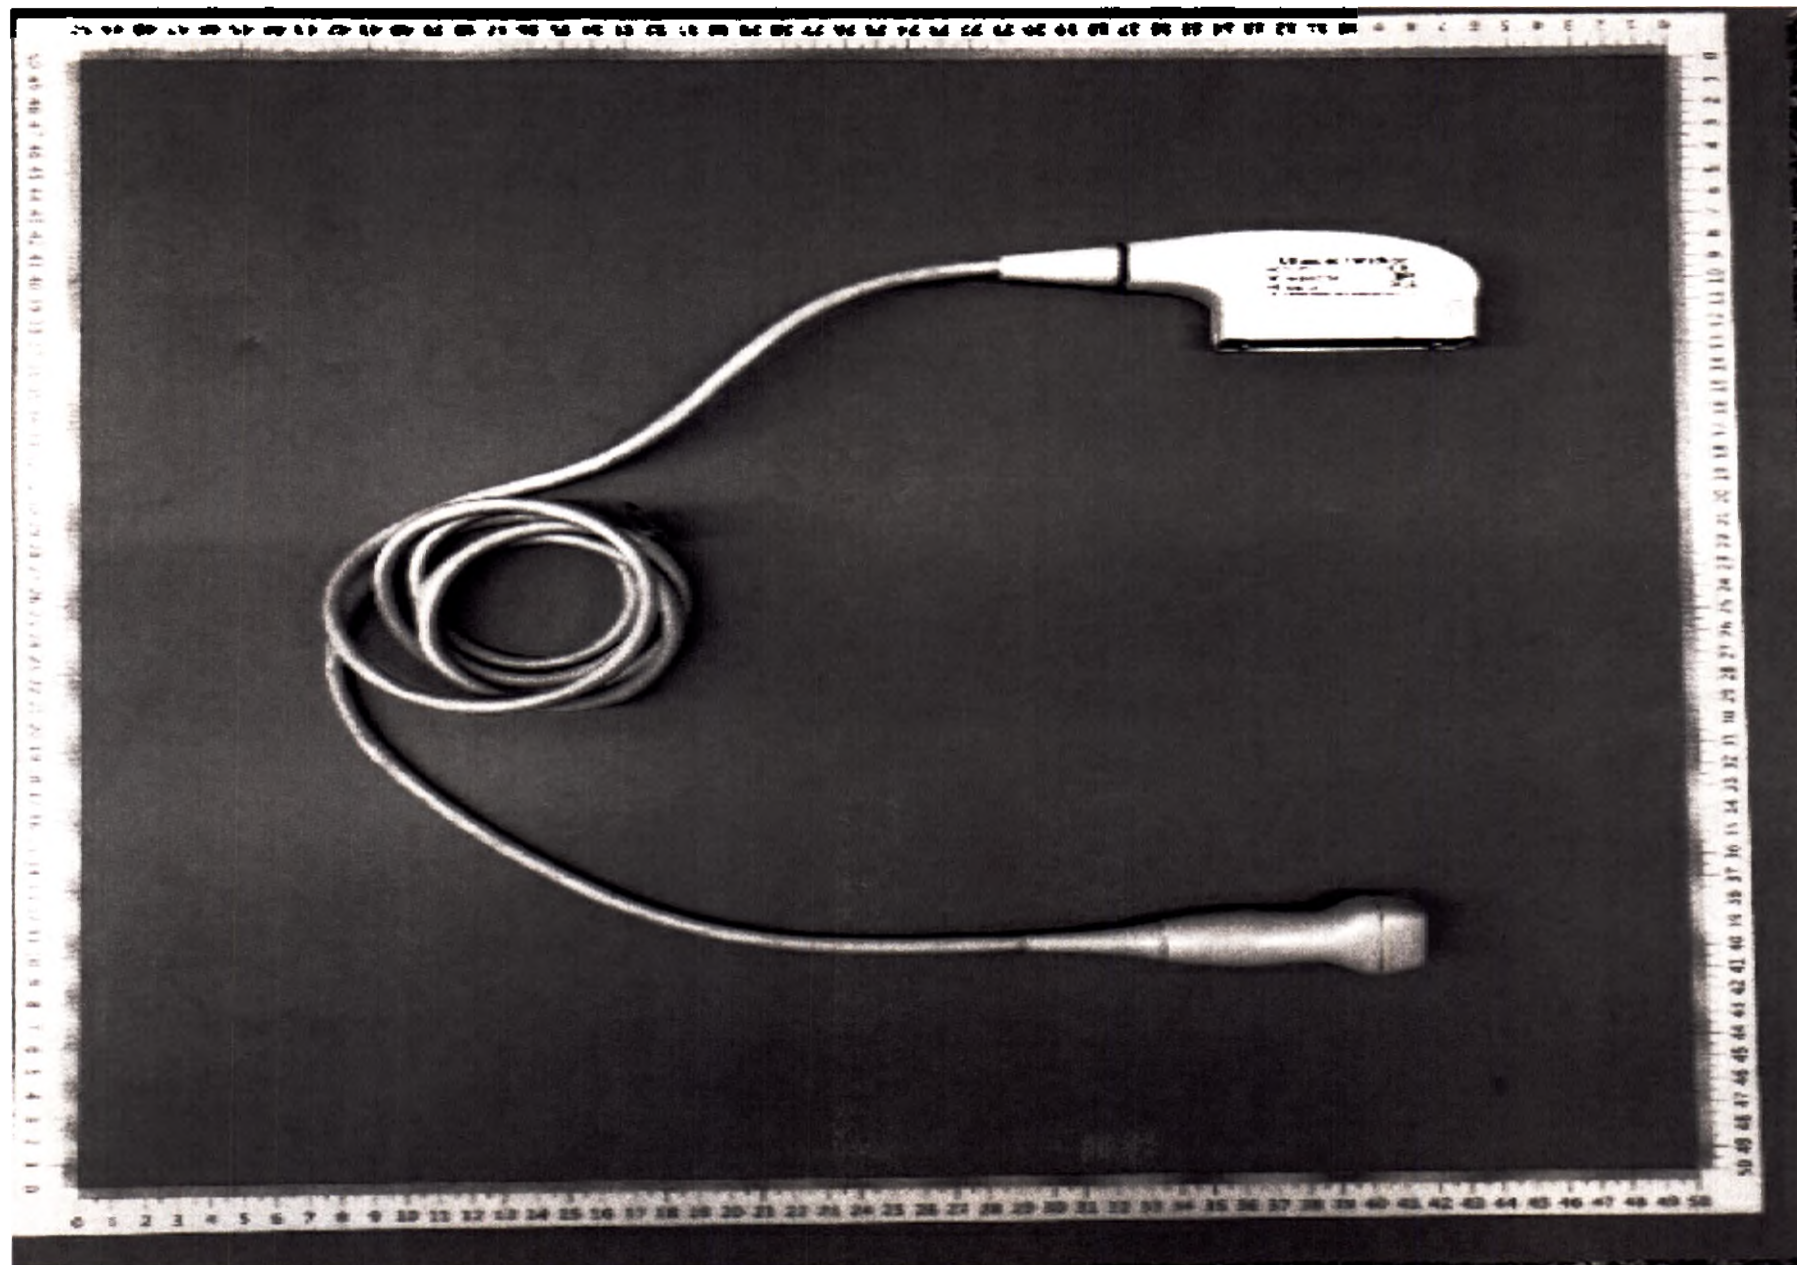



24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный Р7-3Ts в составе:

24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

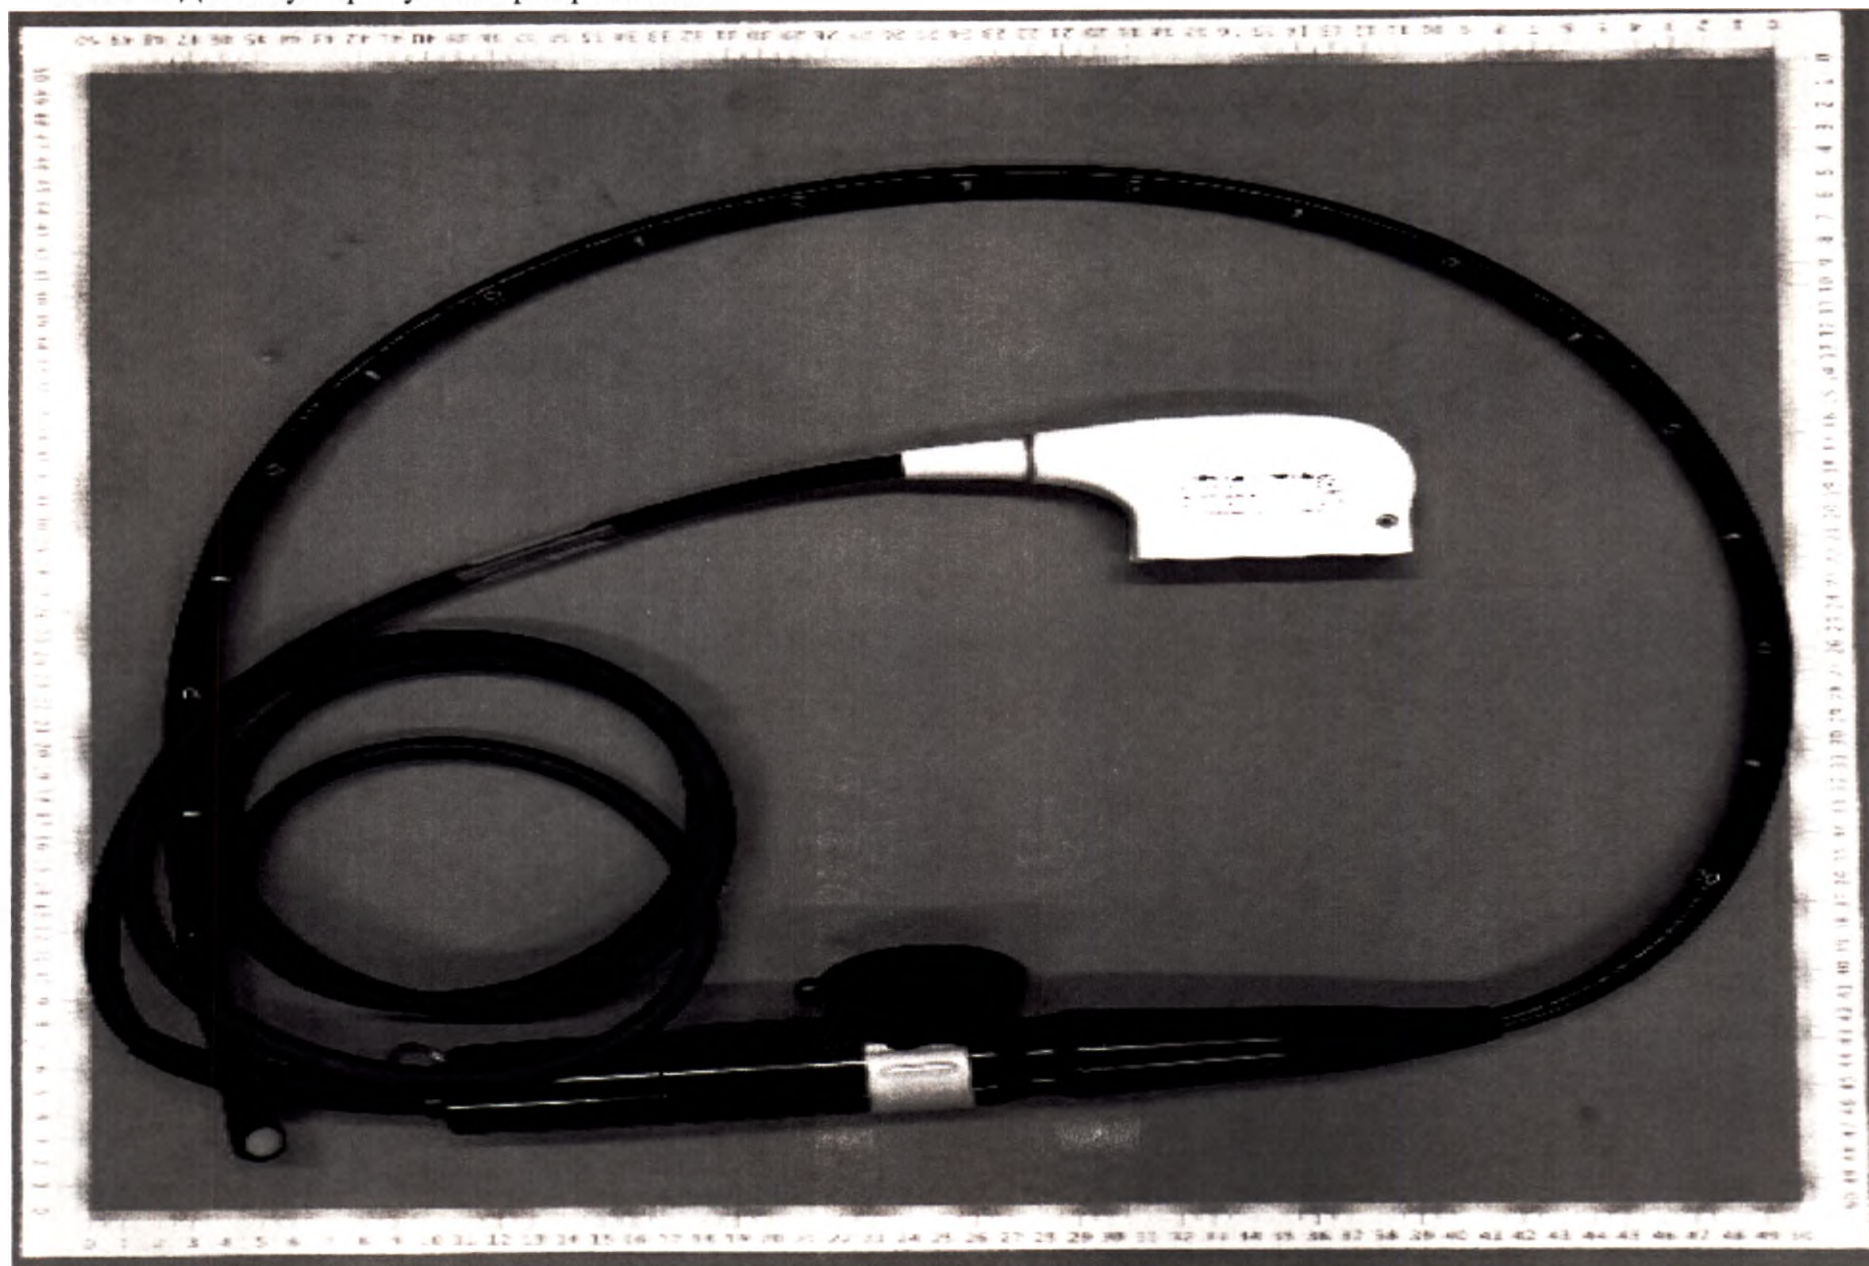

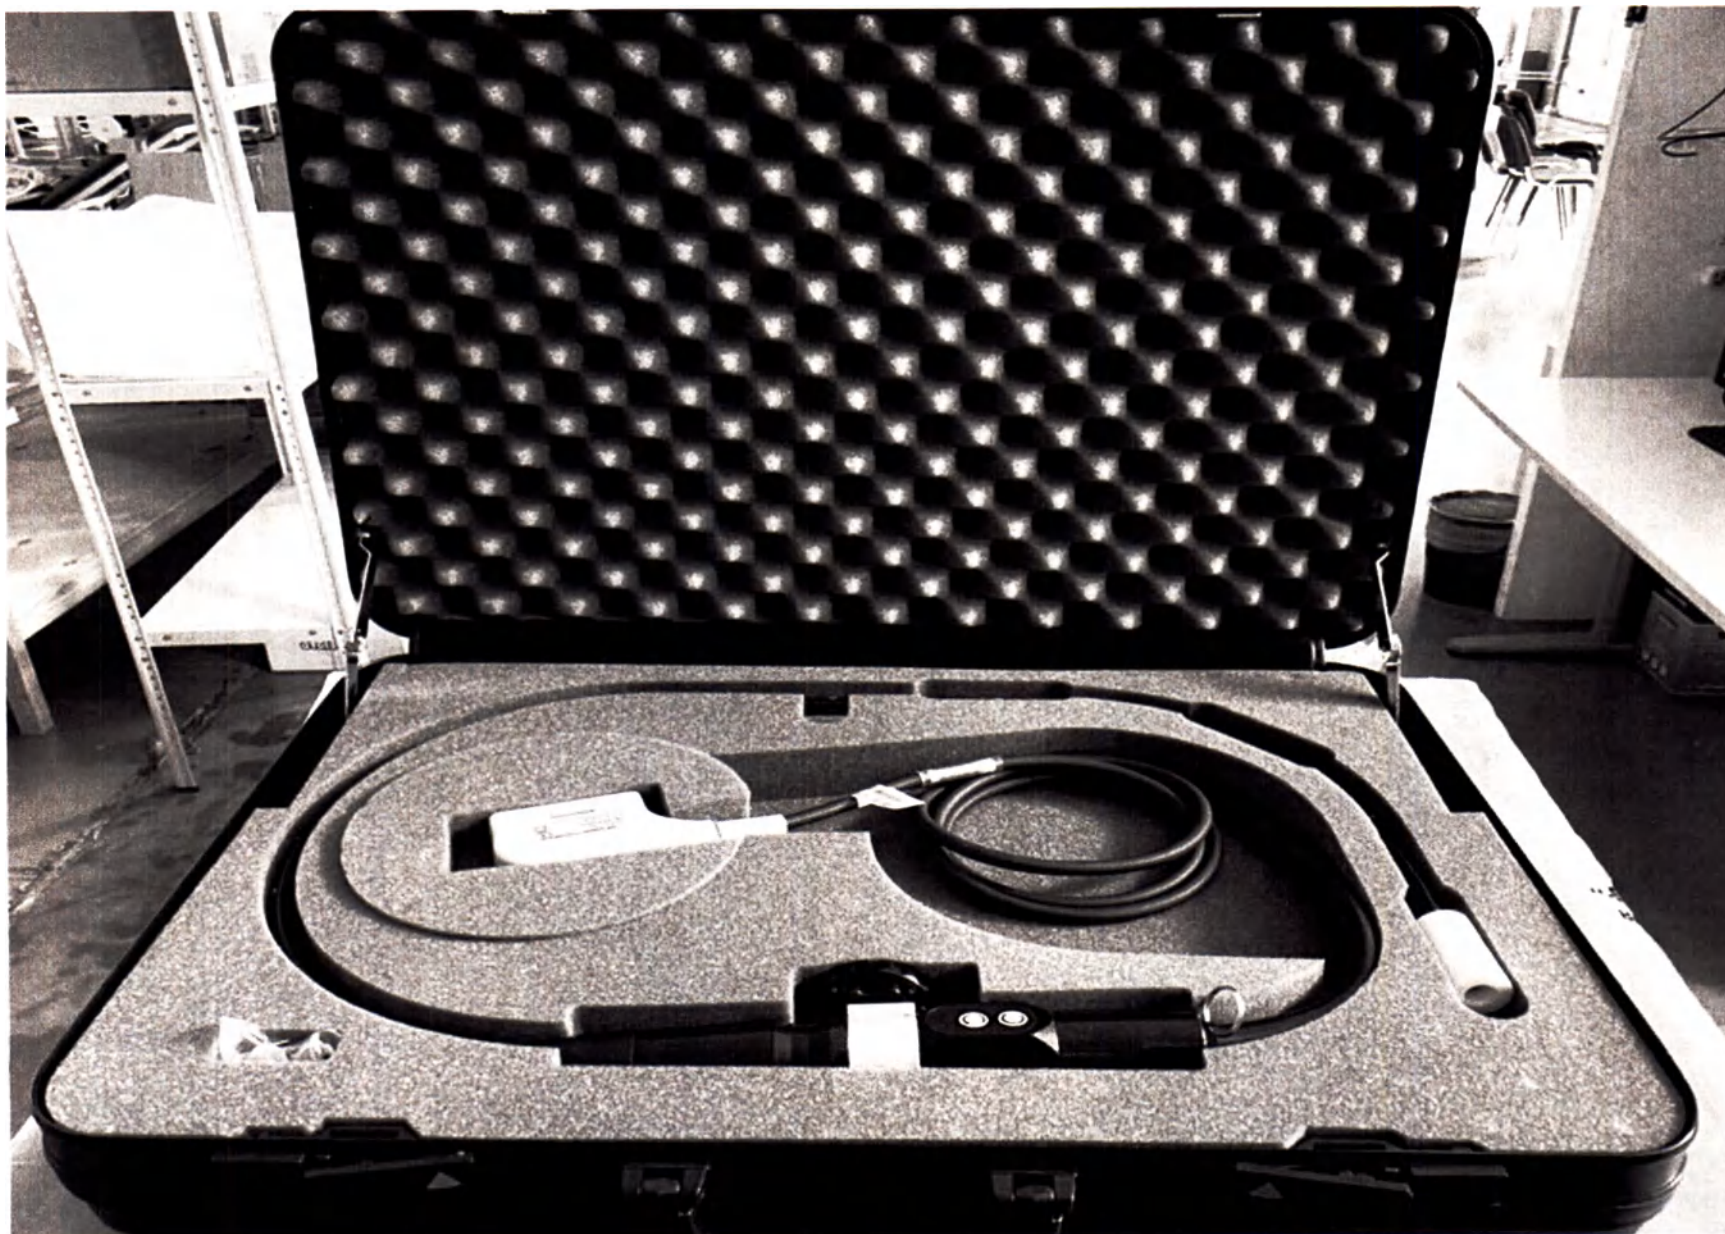


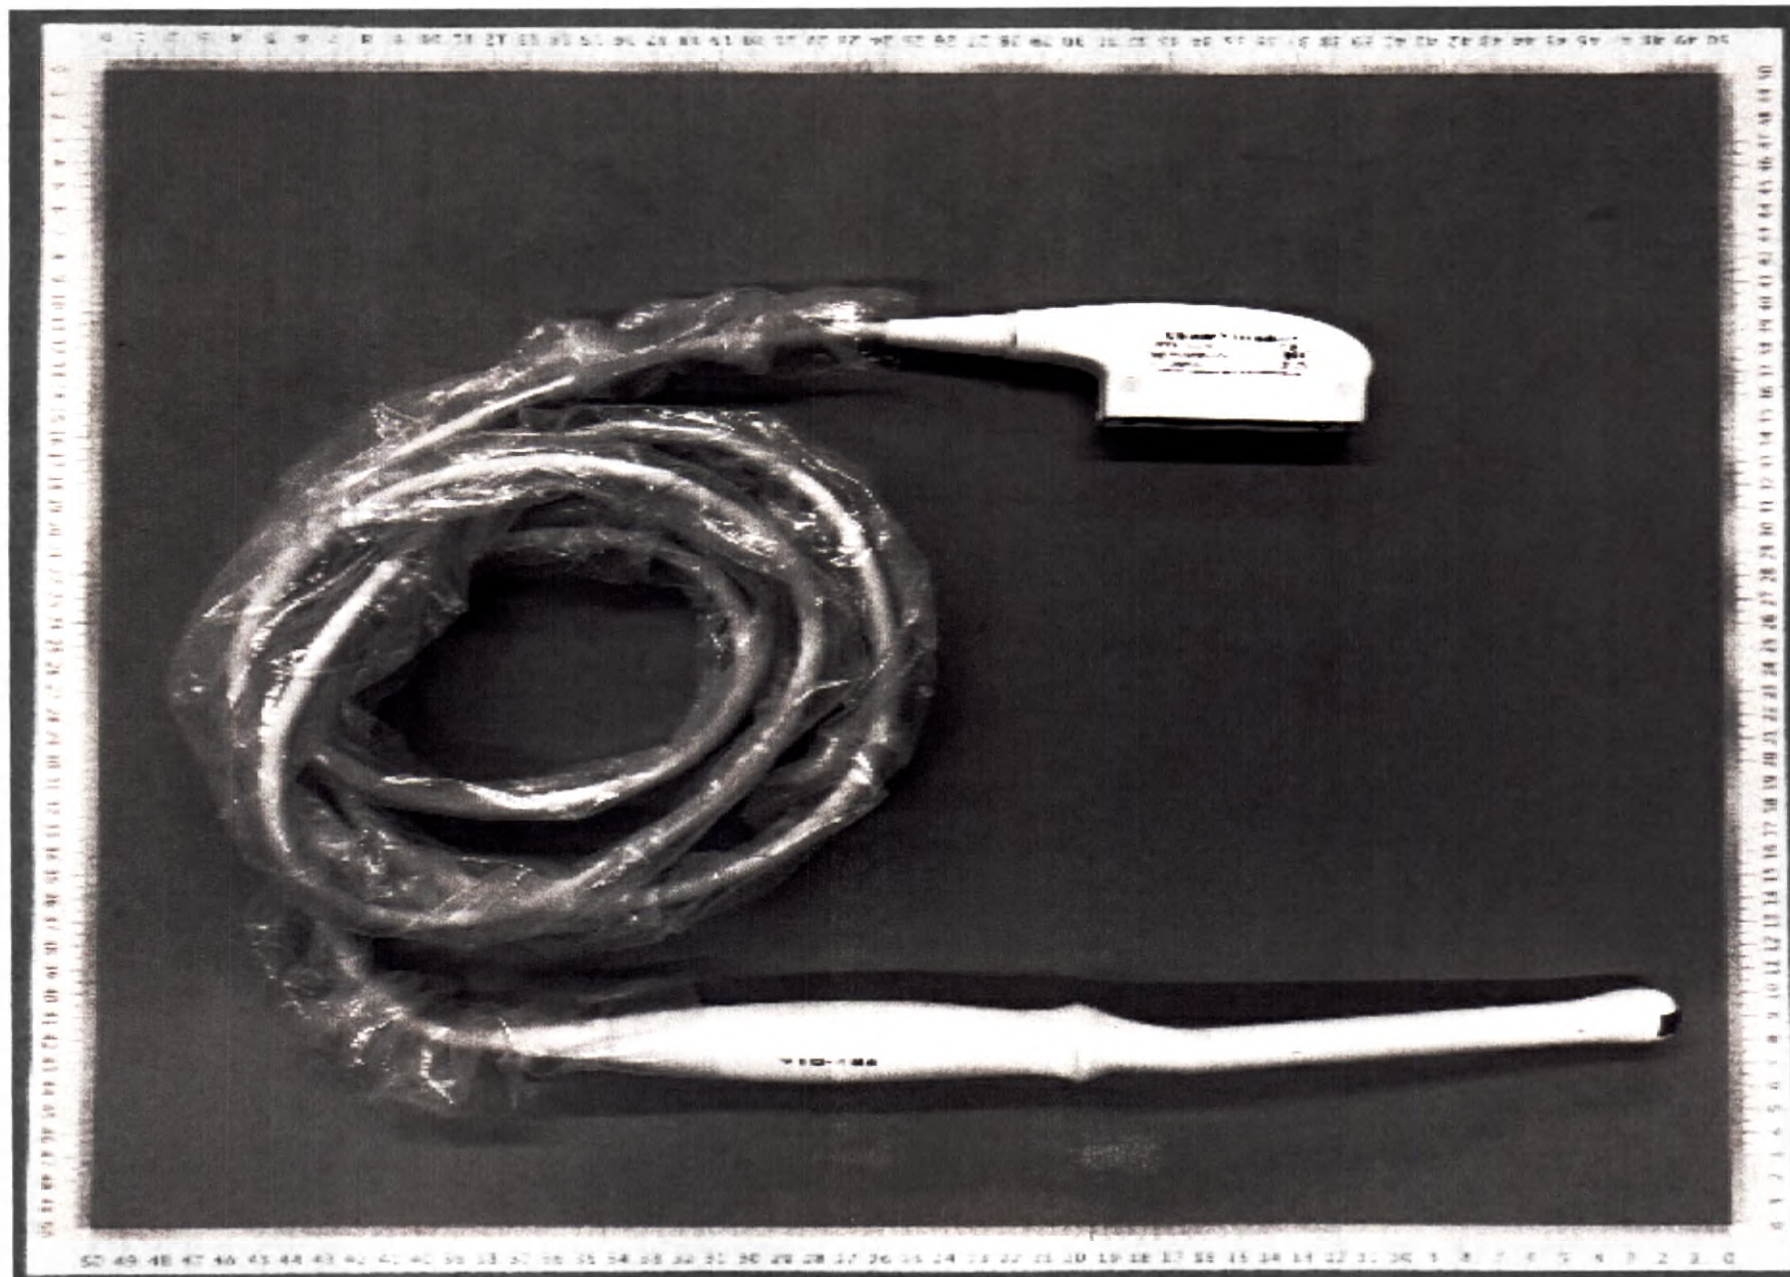

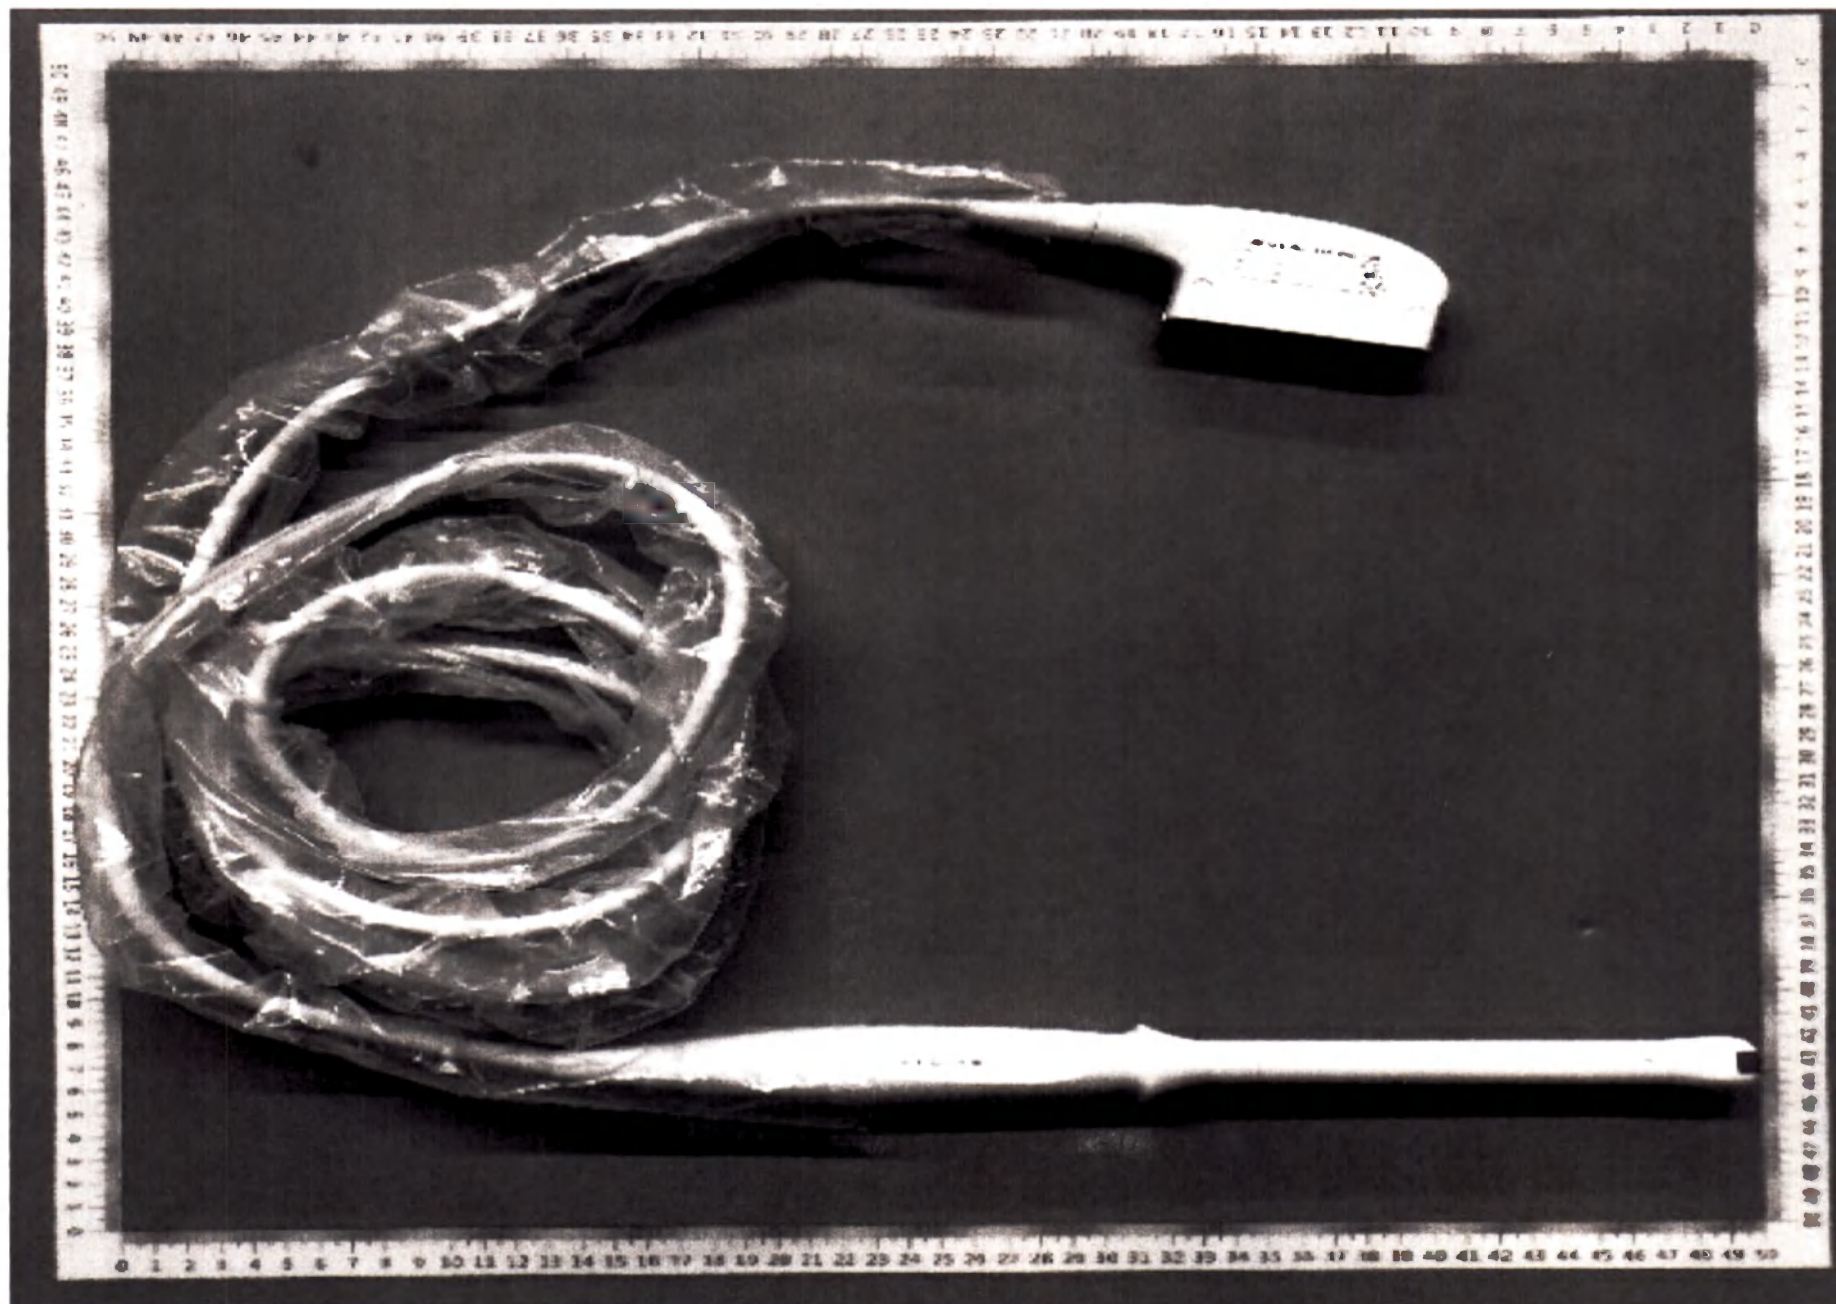



25. Насадки биопсийные, варианты исполнения


25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

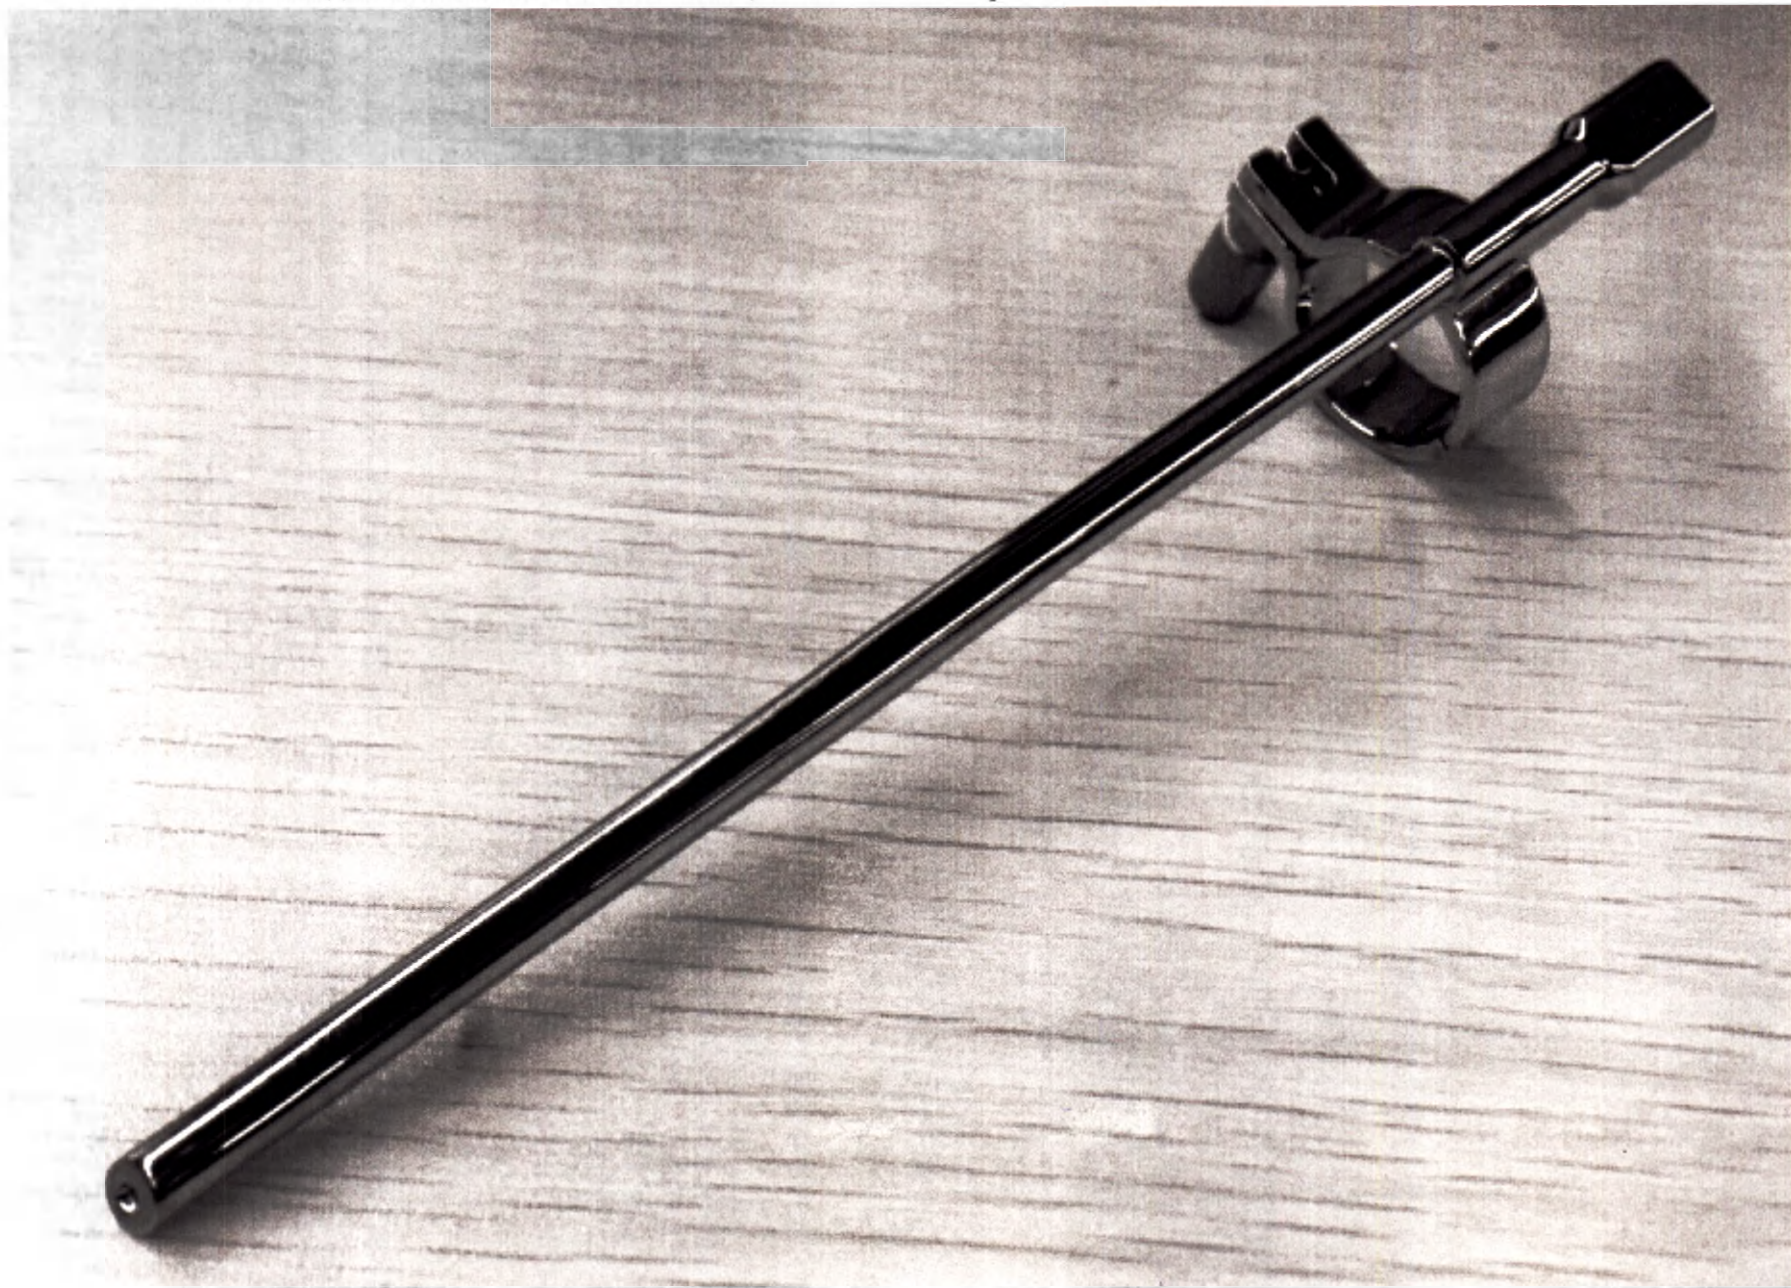





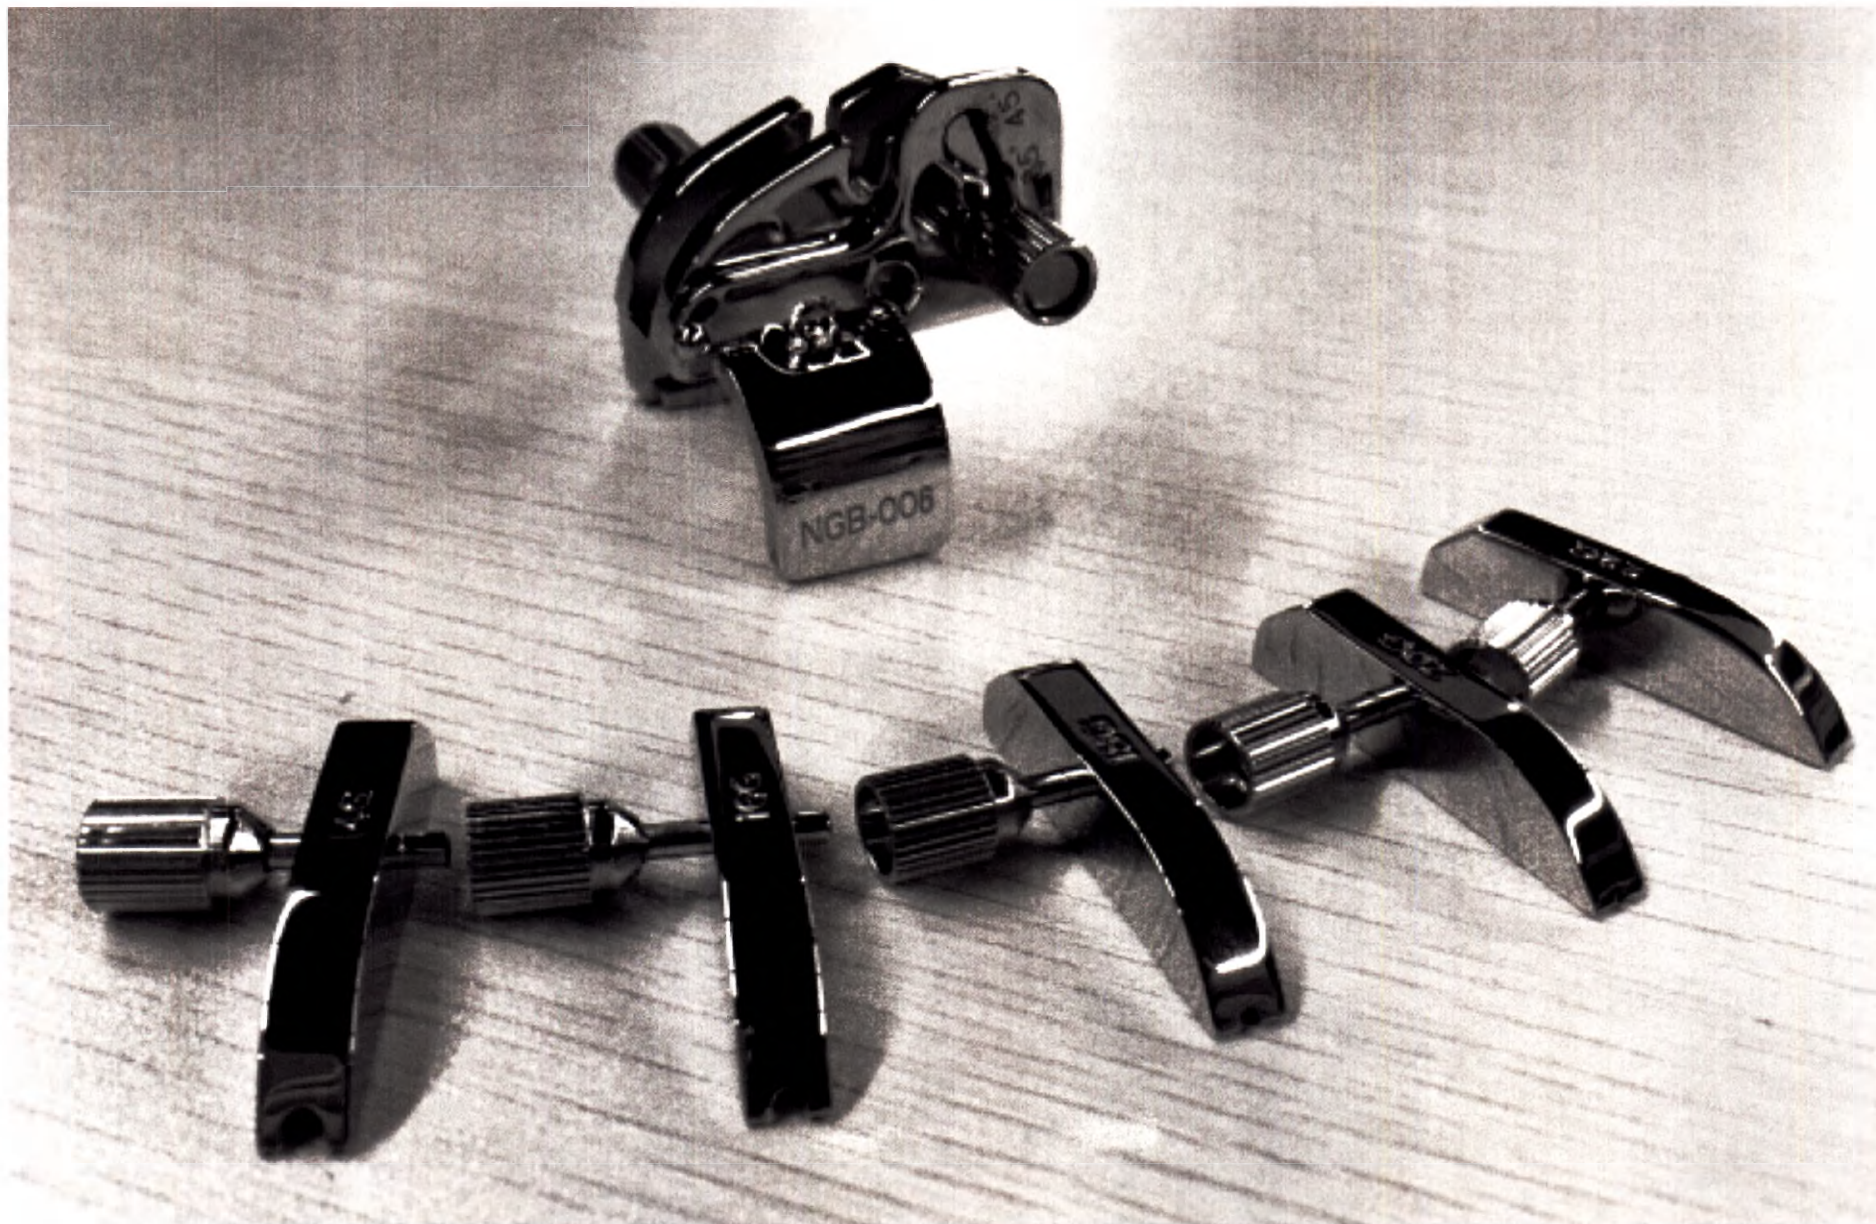



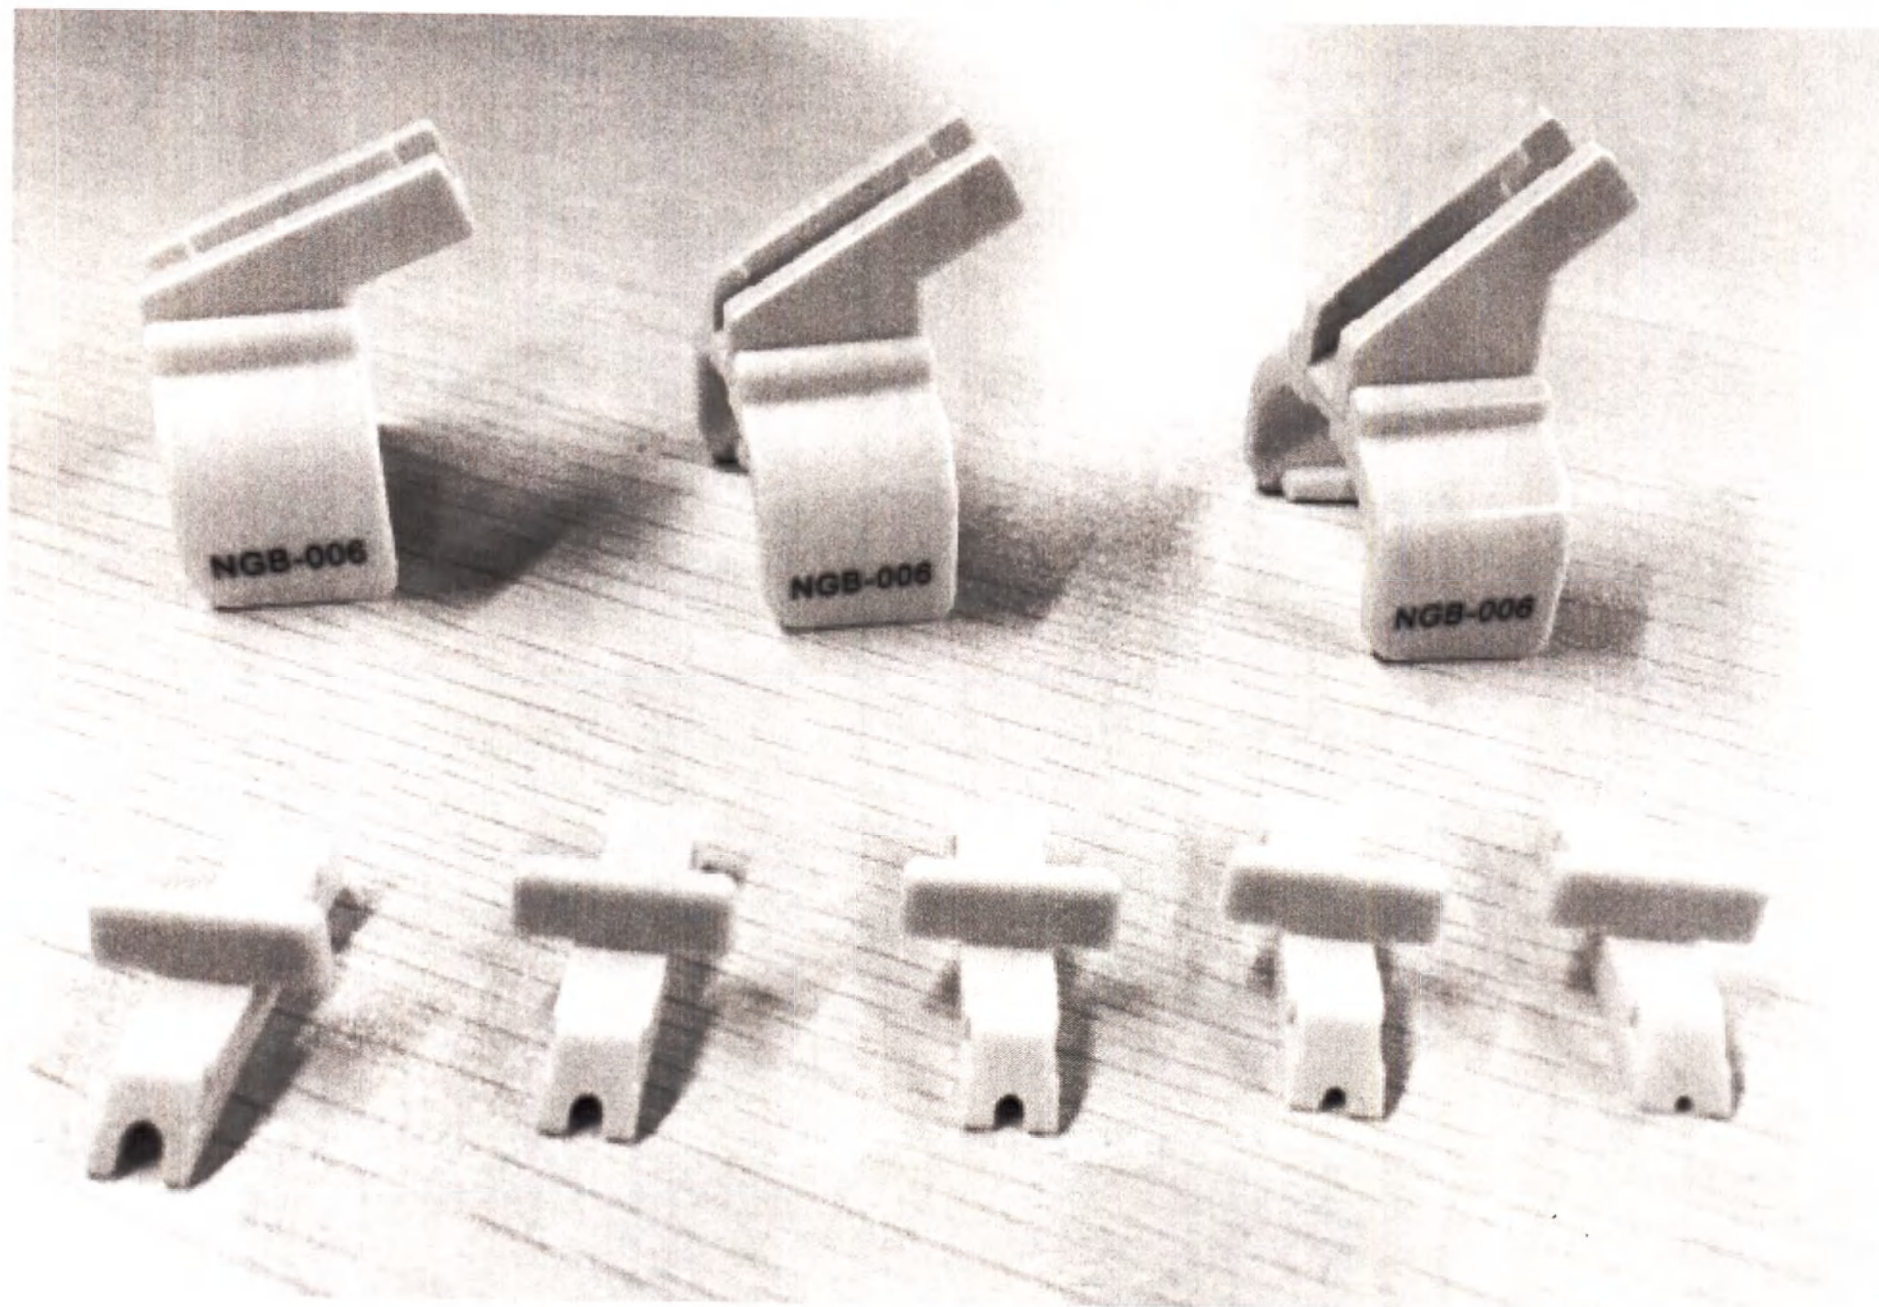


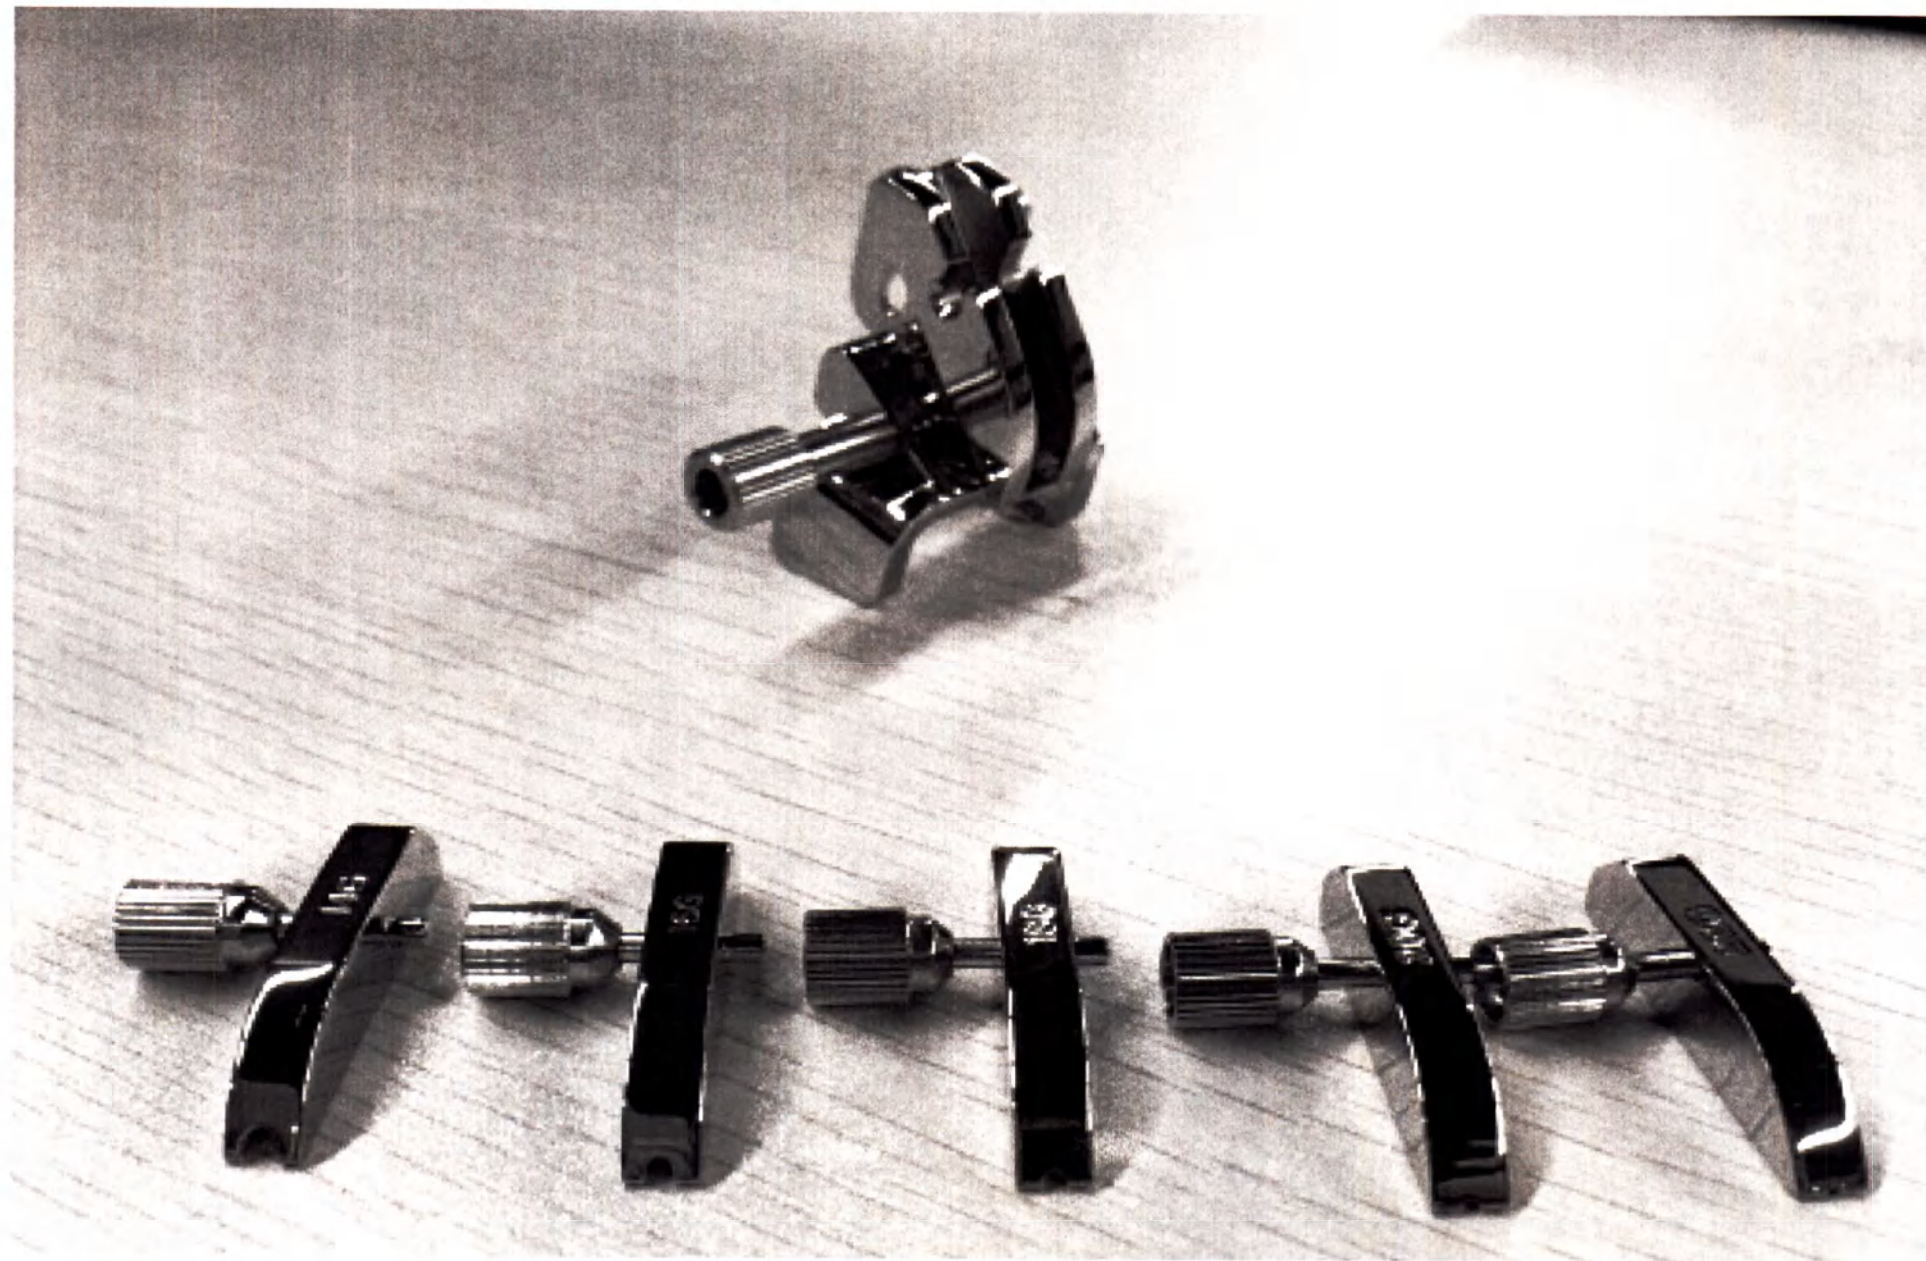


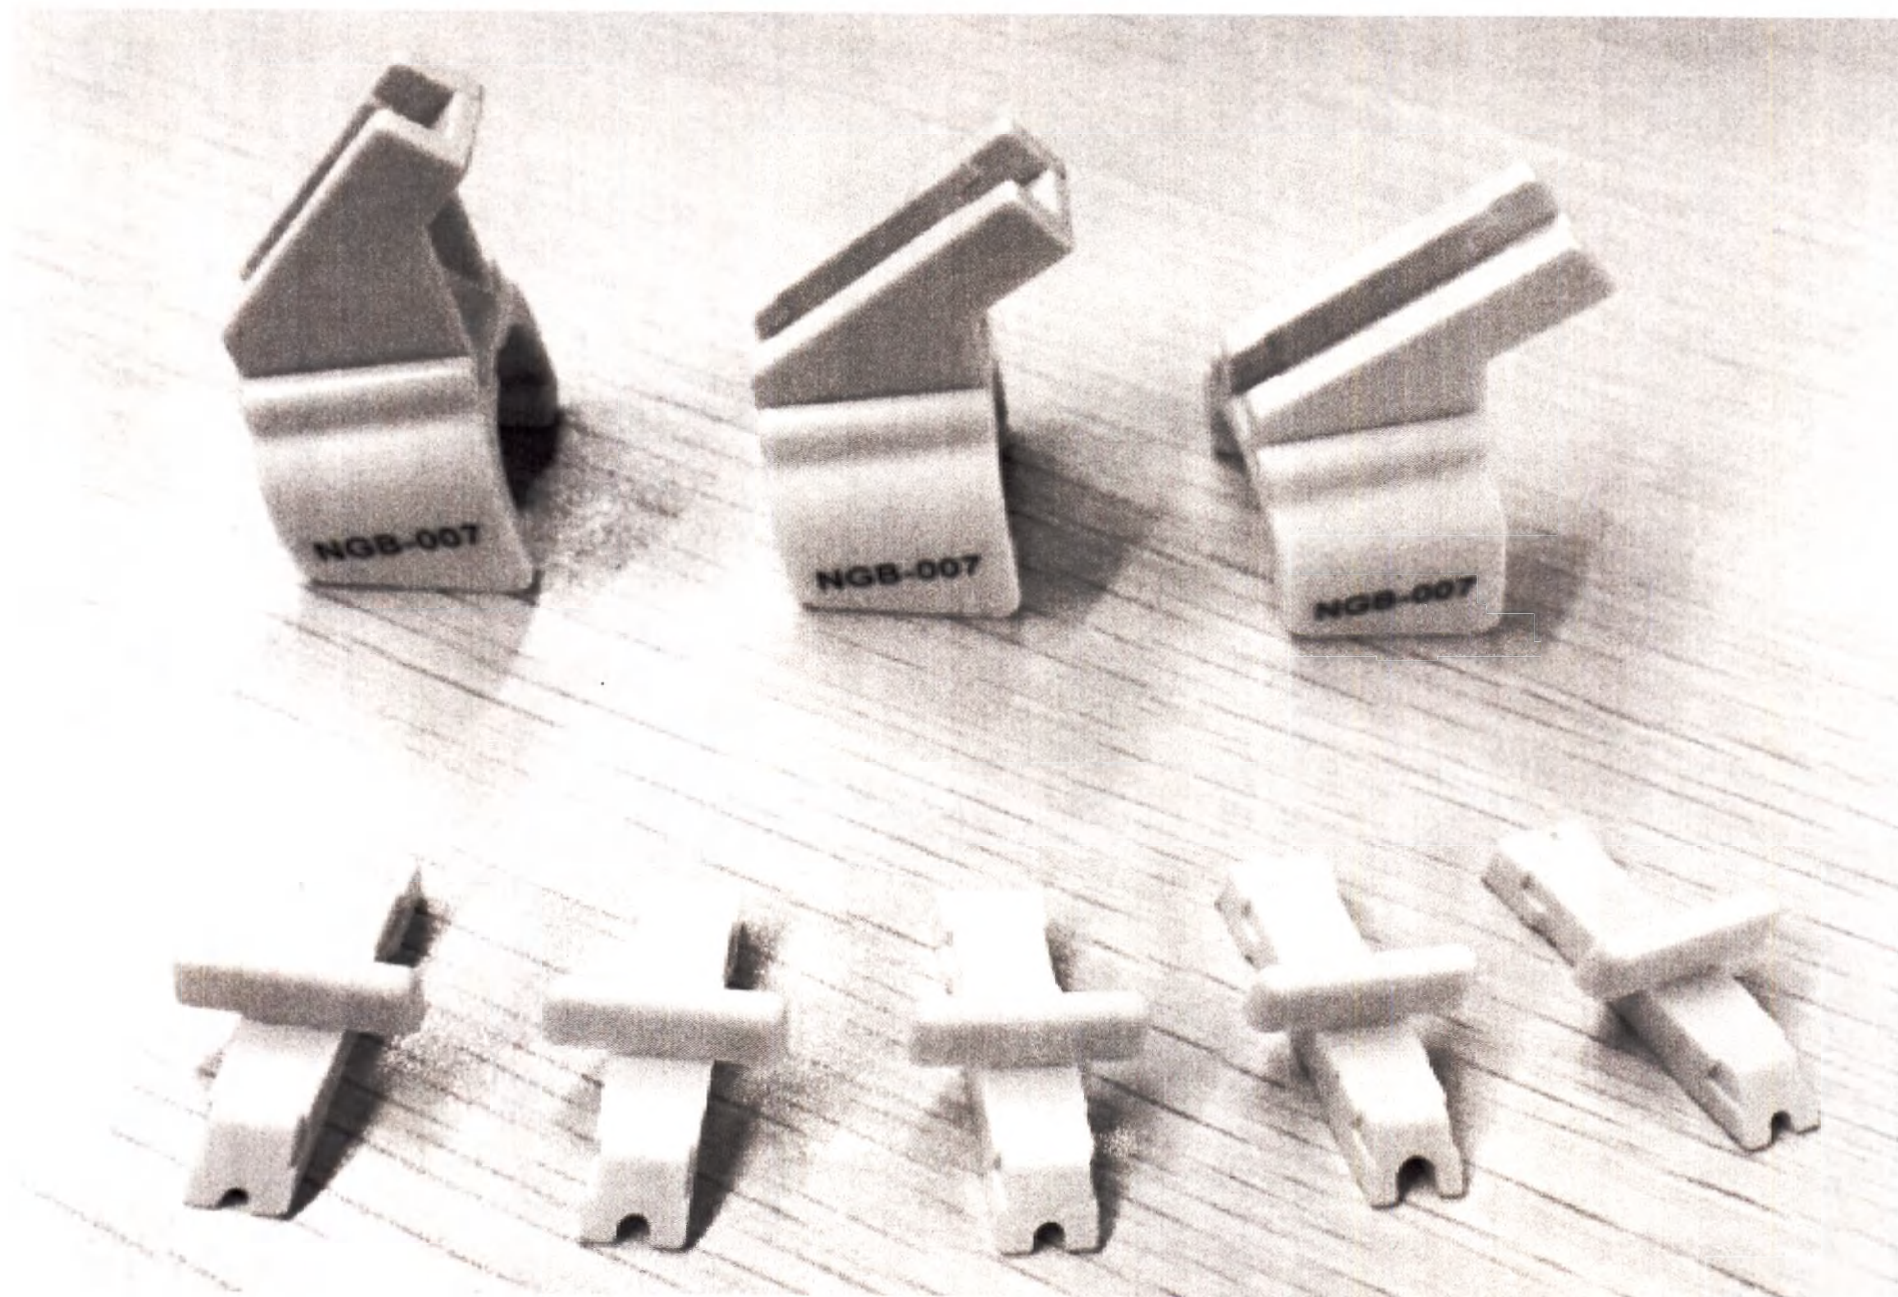

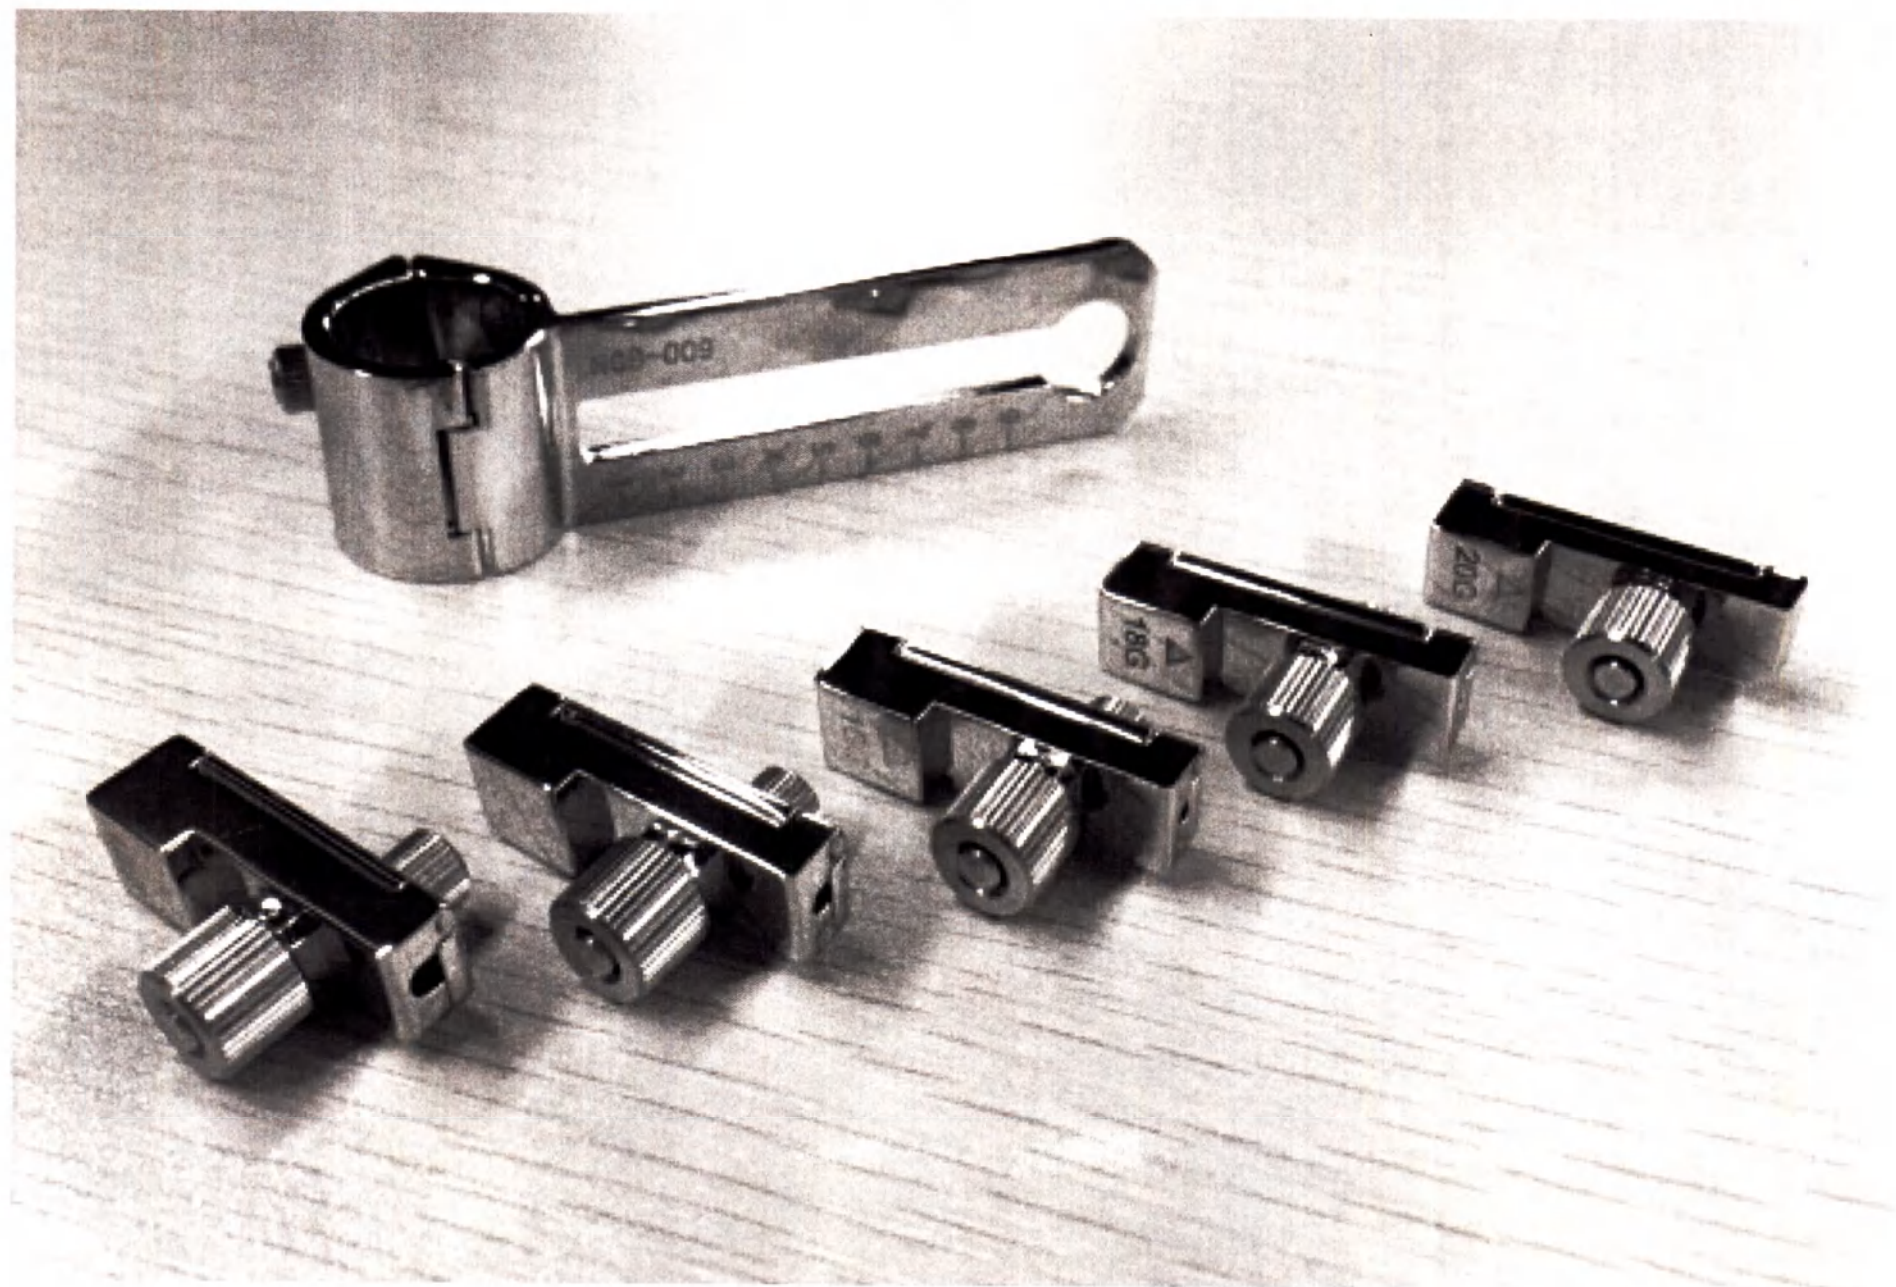


25.8. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-010

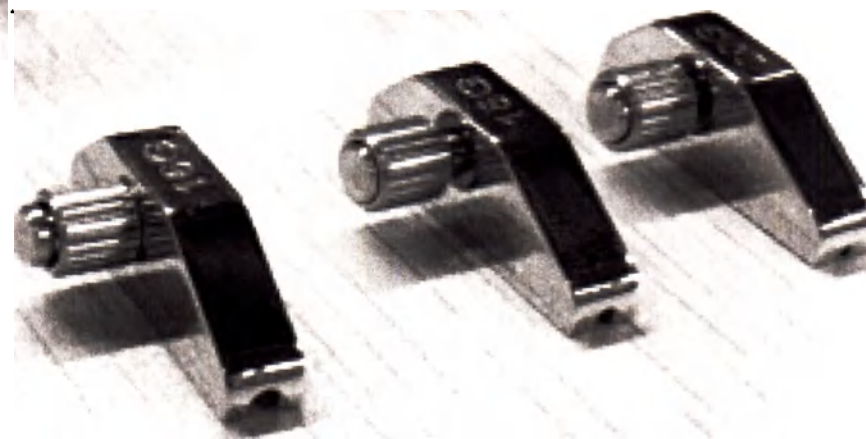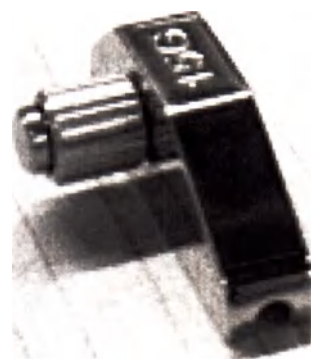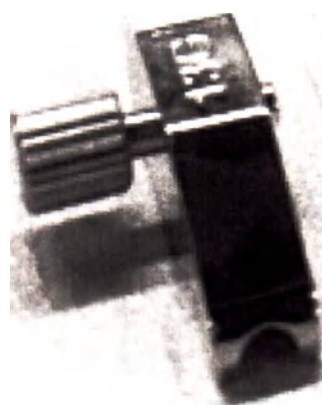

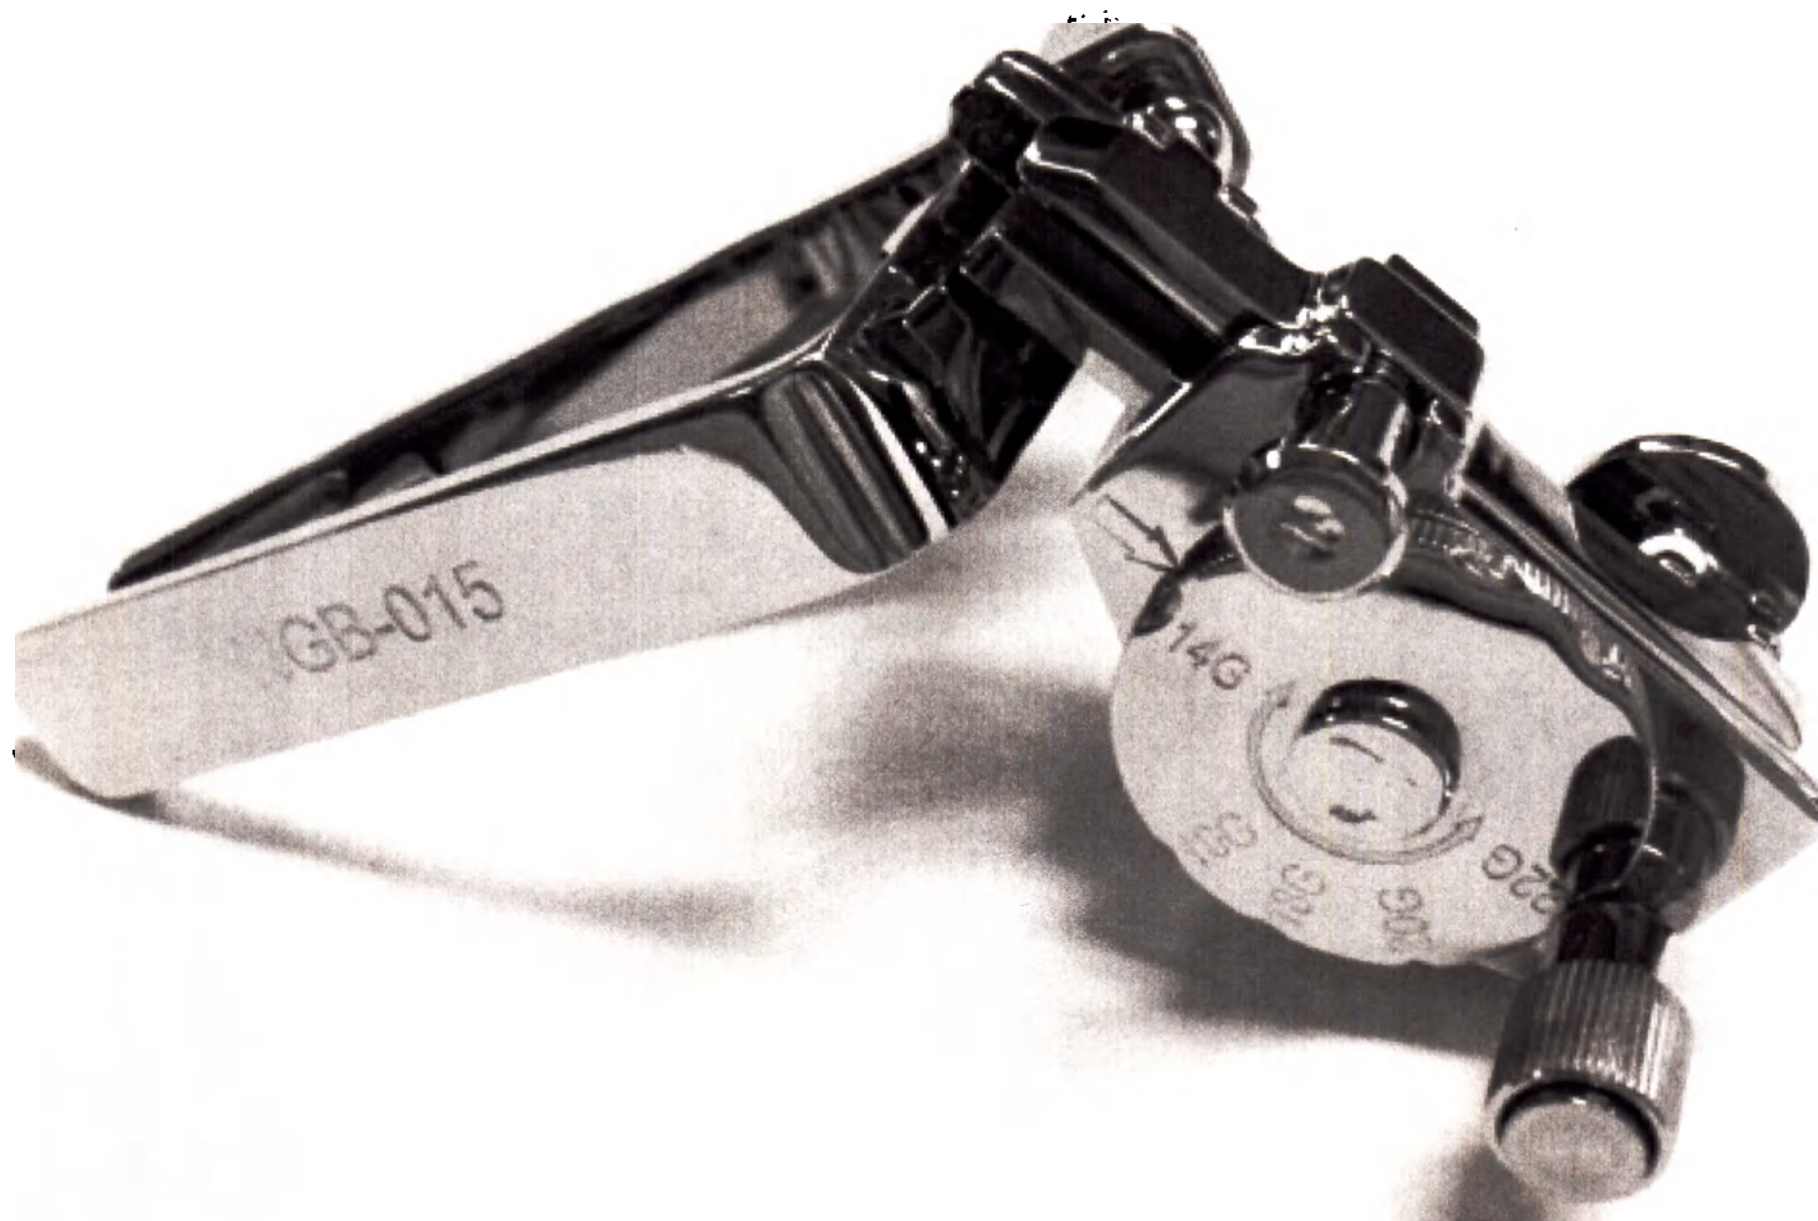




25.11. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018

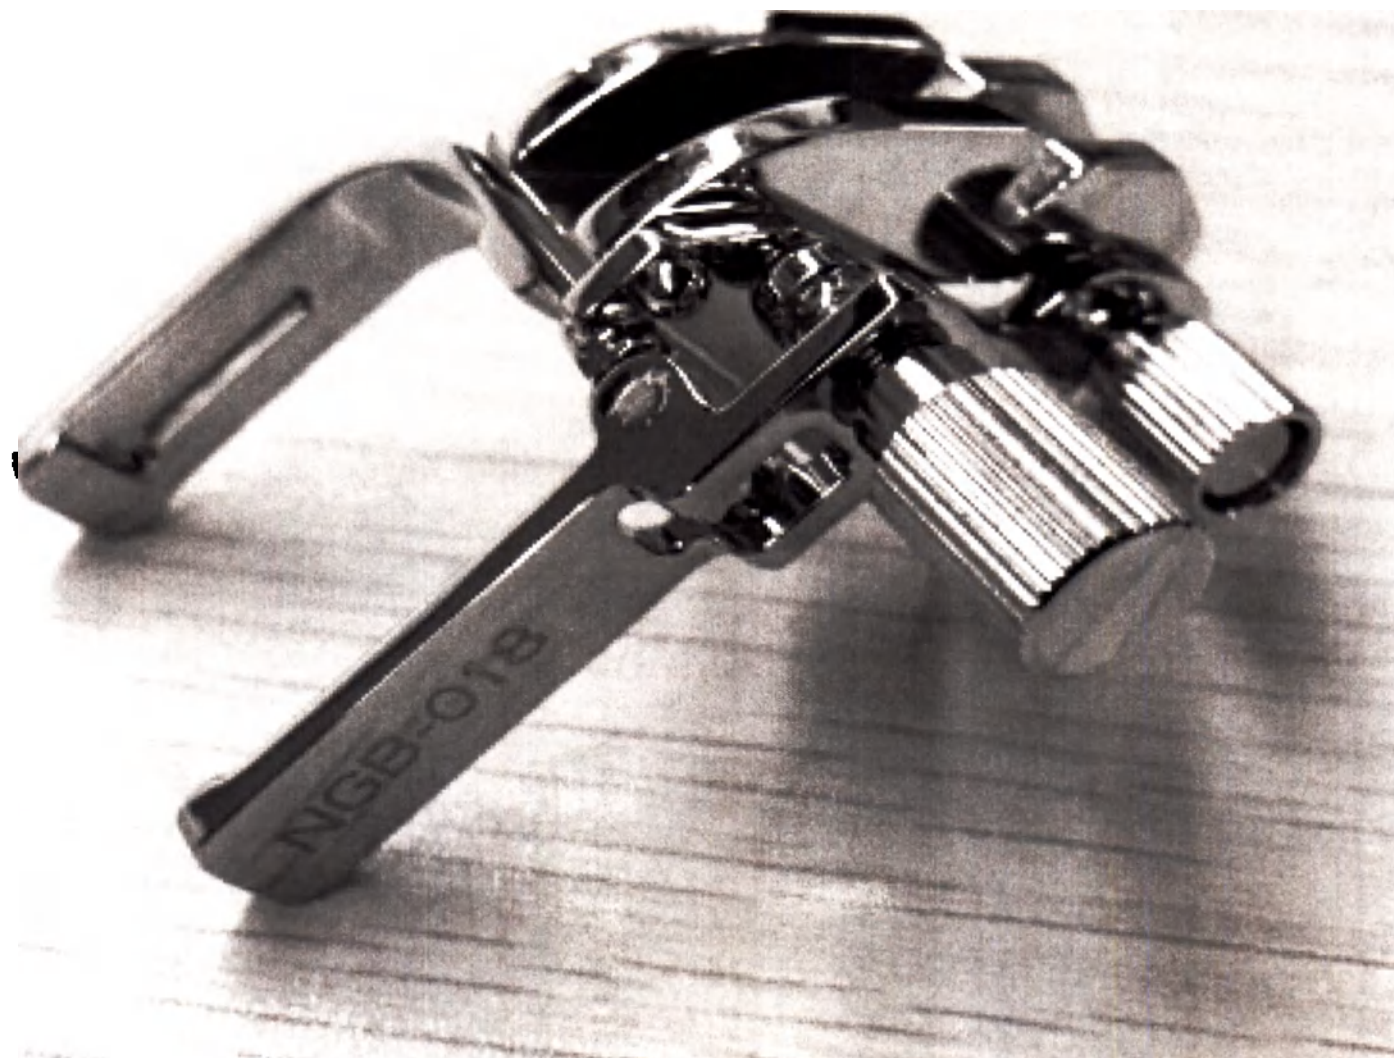


26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)

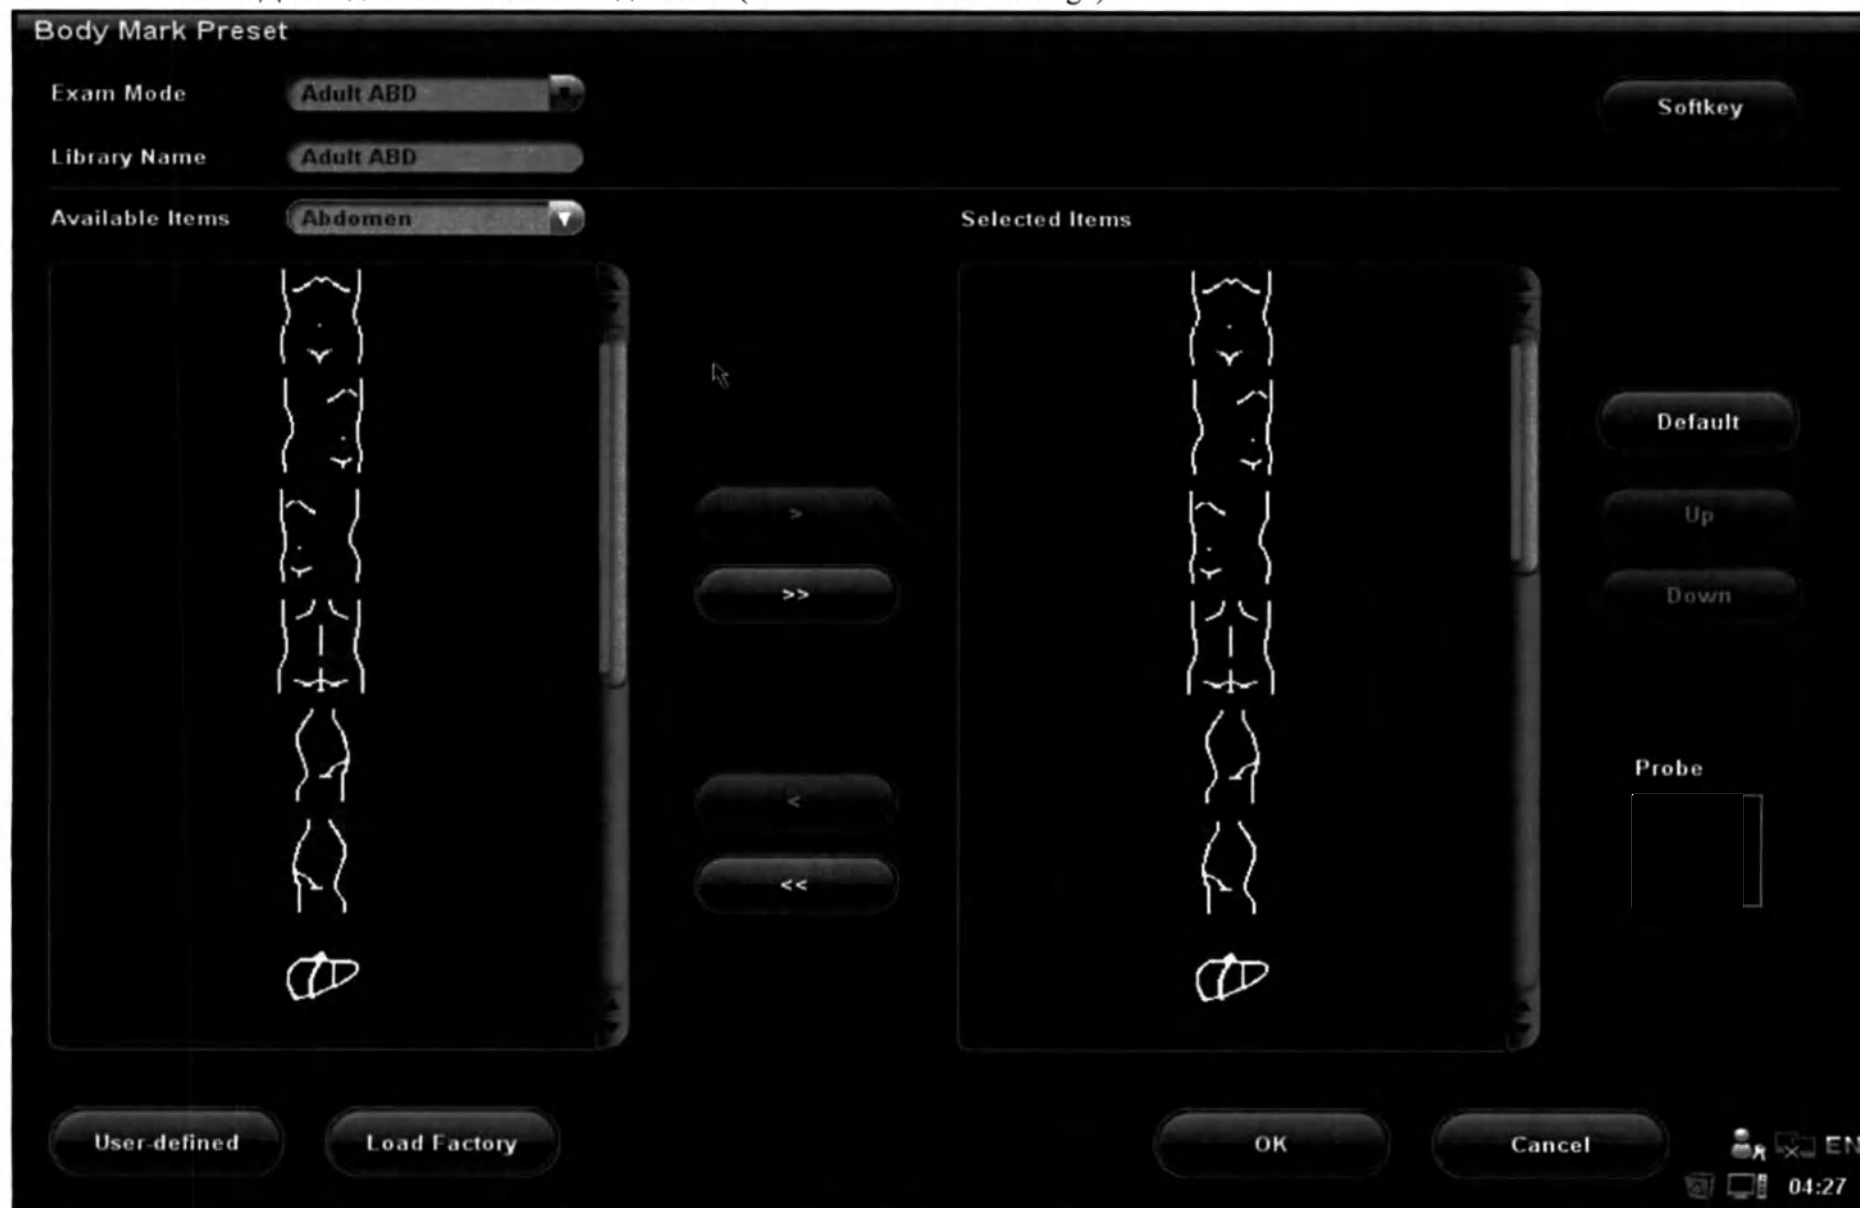




26.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package)

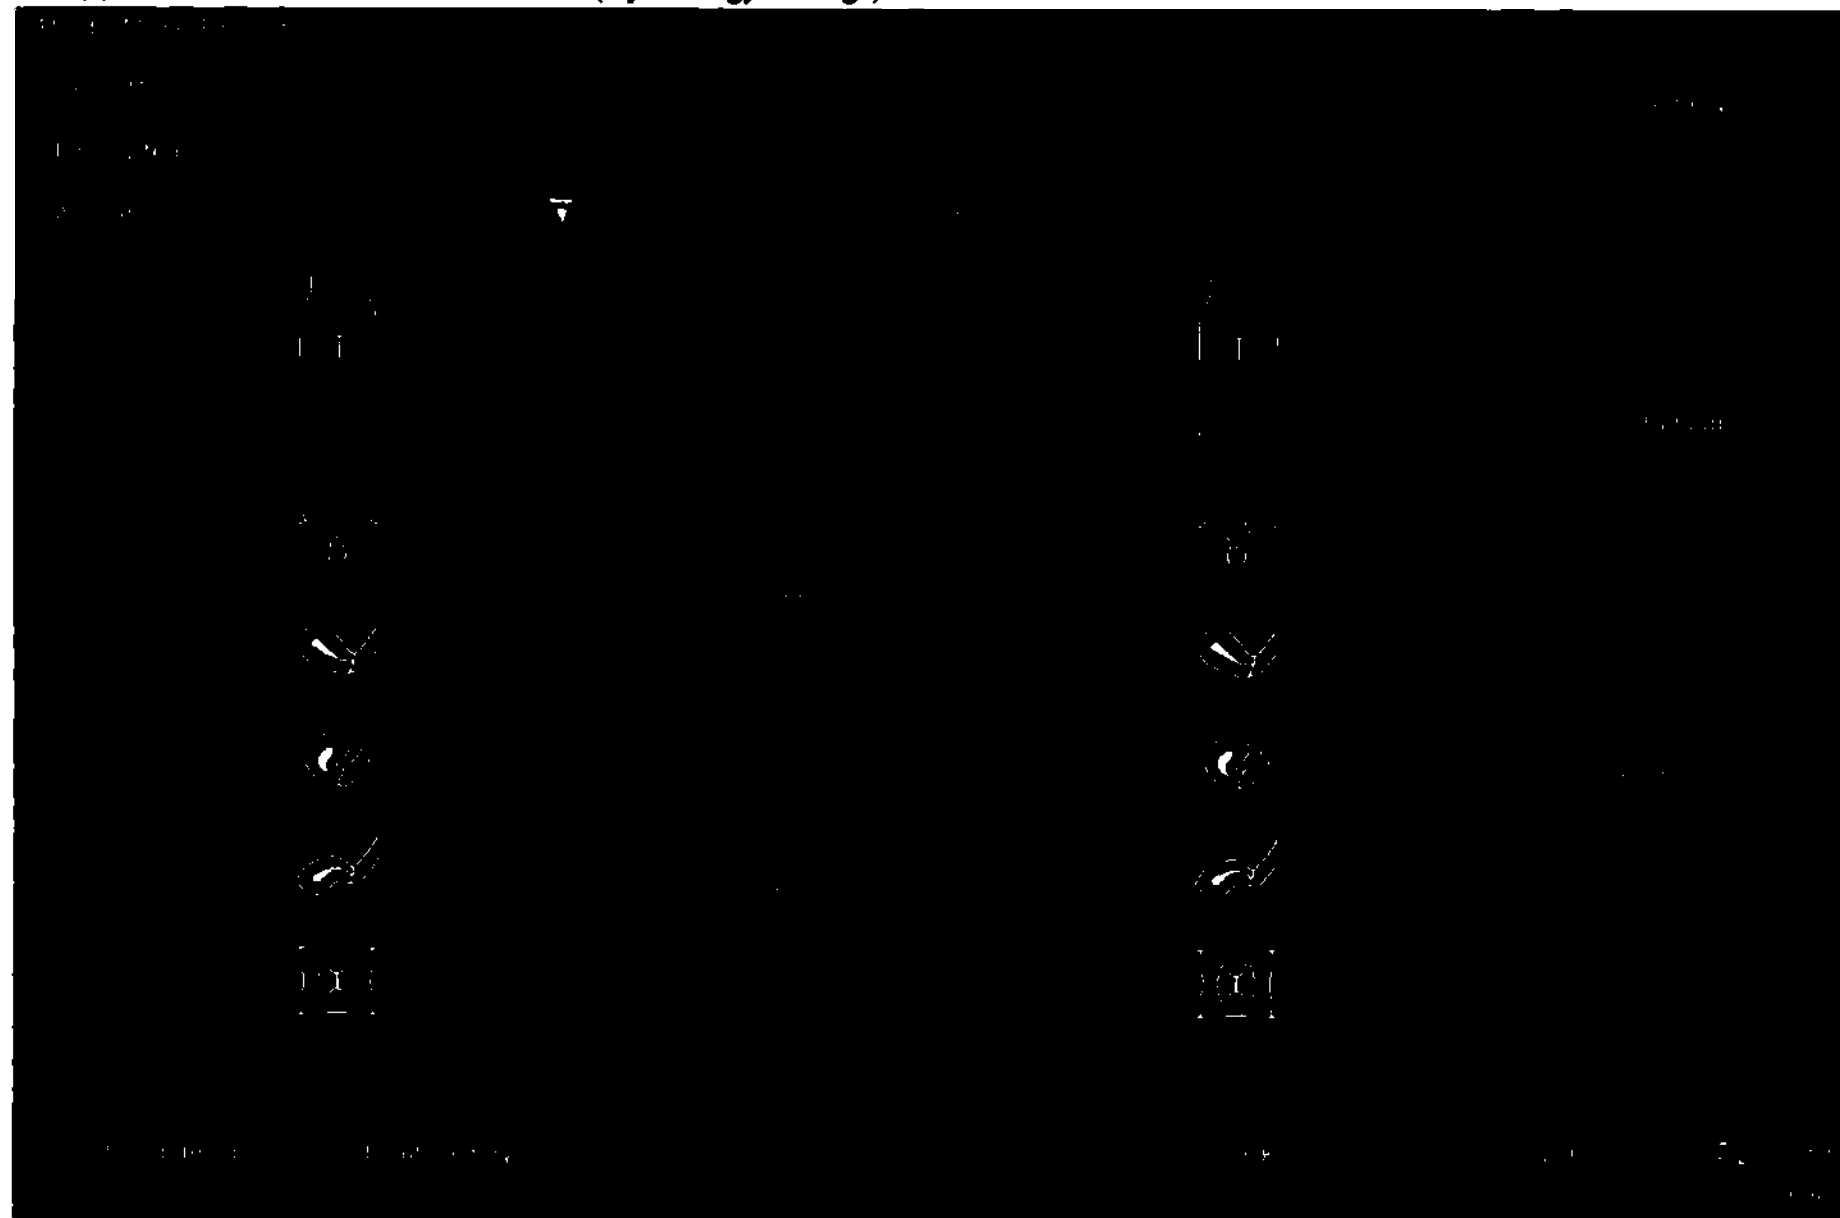


26.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package)




26.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package)

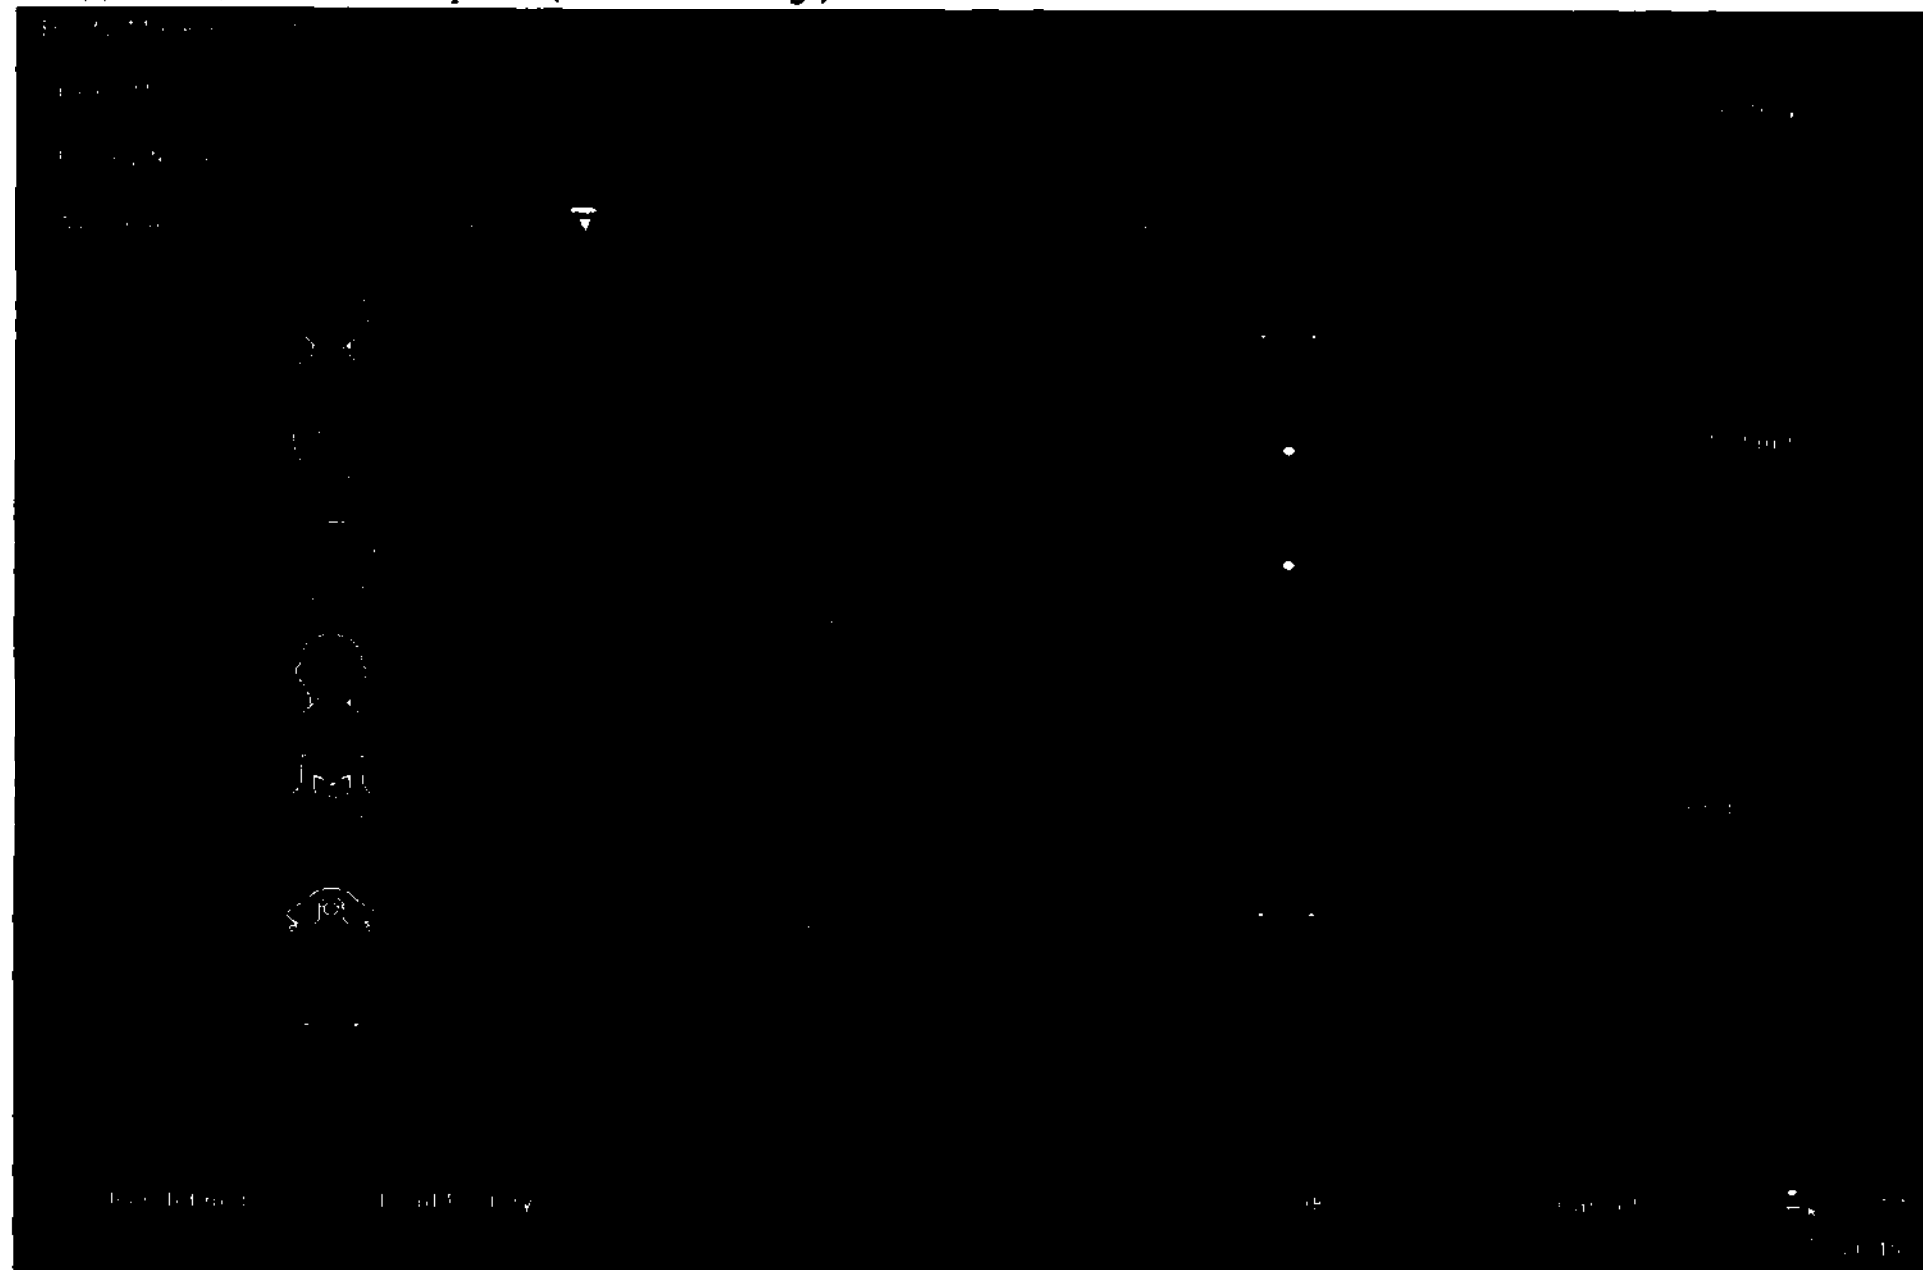

26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

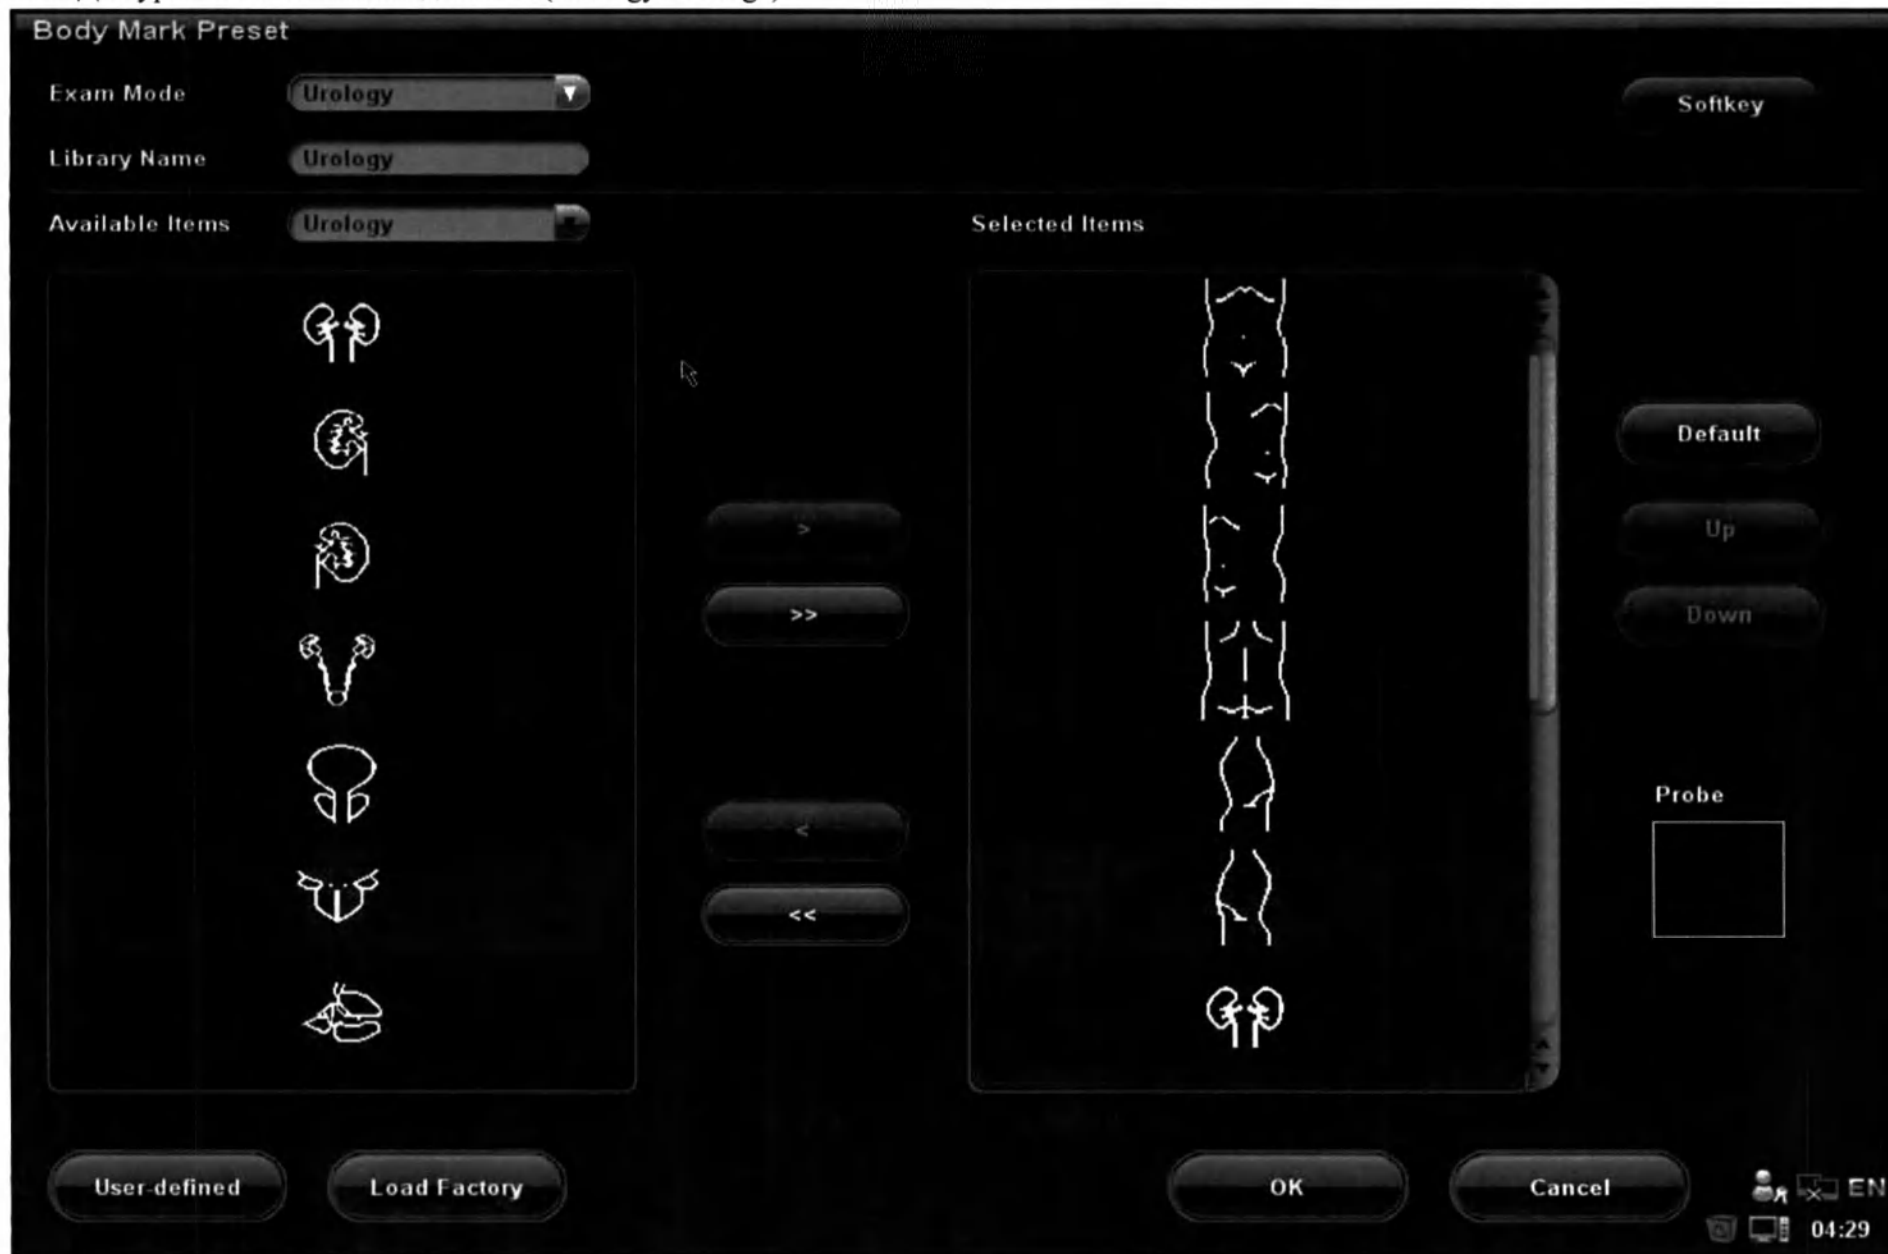


26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)

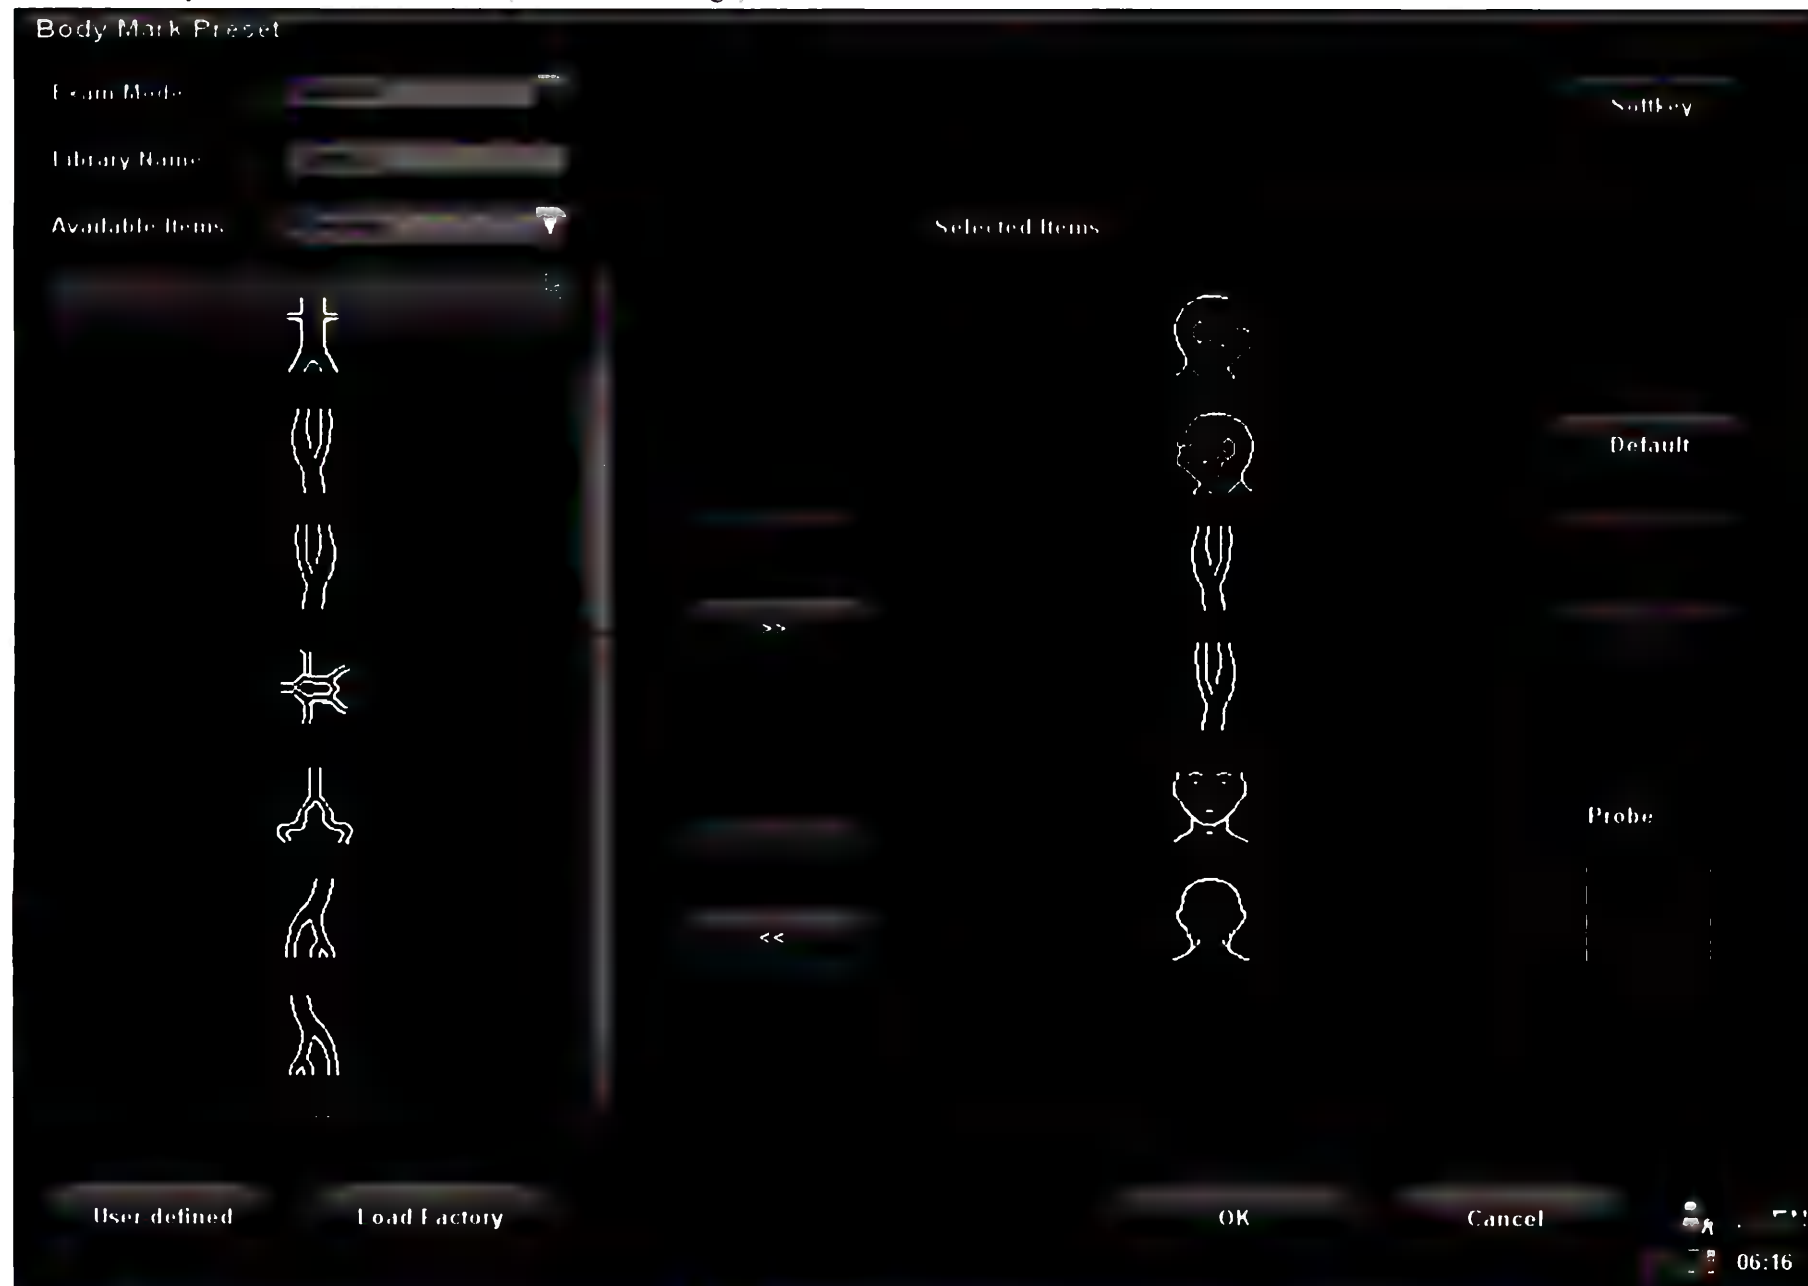




26.9. Для исследований нервов (Nerve Package)

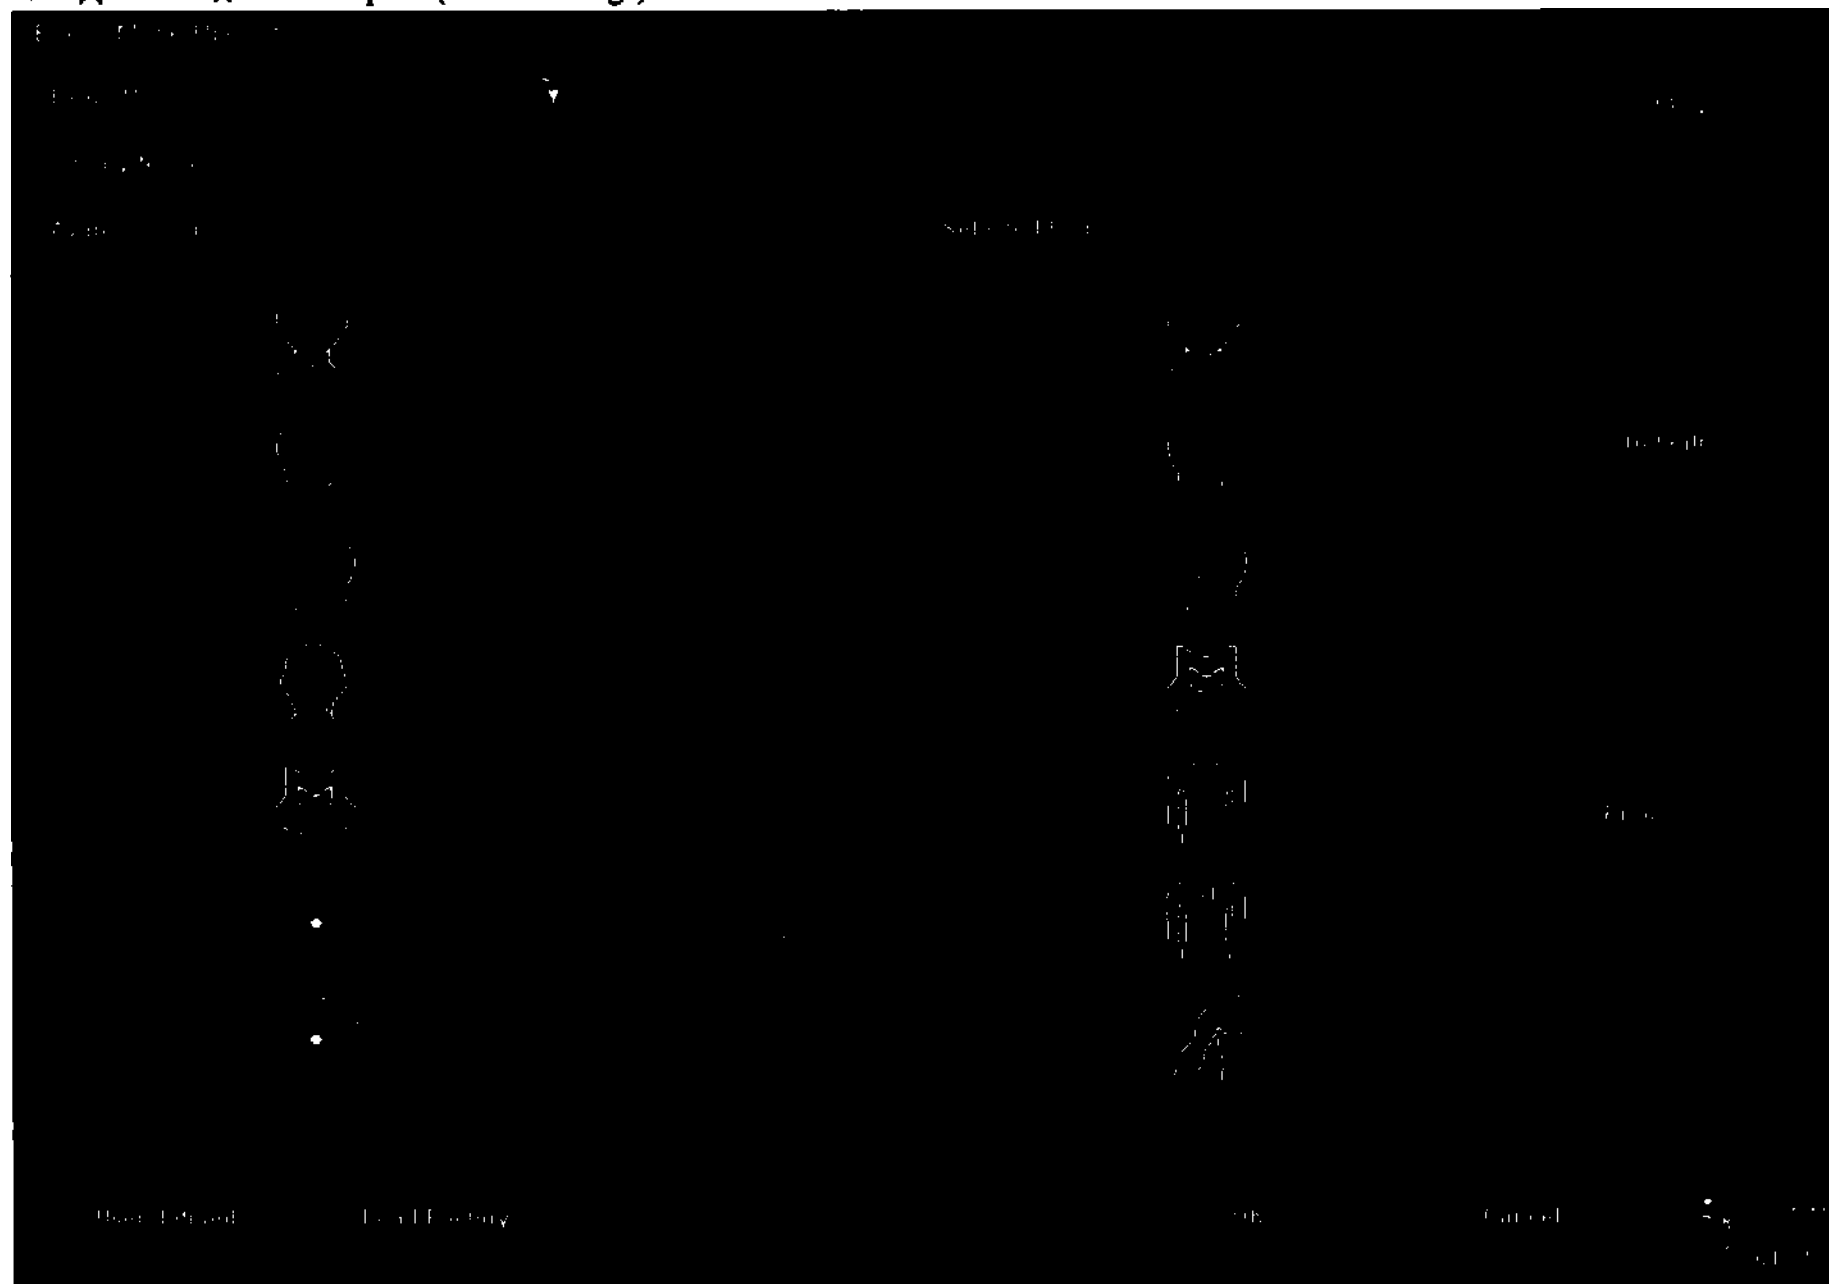





26.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)

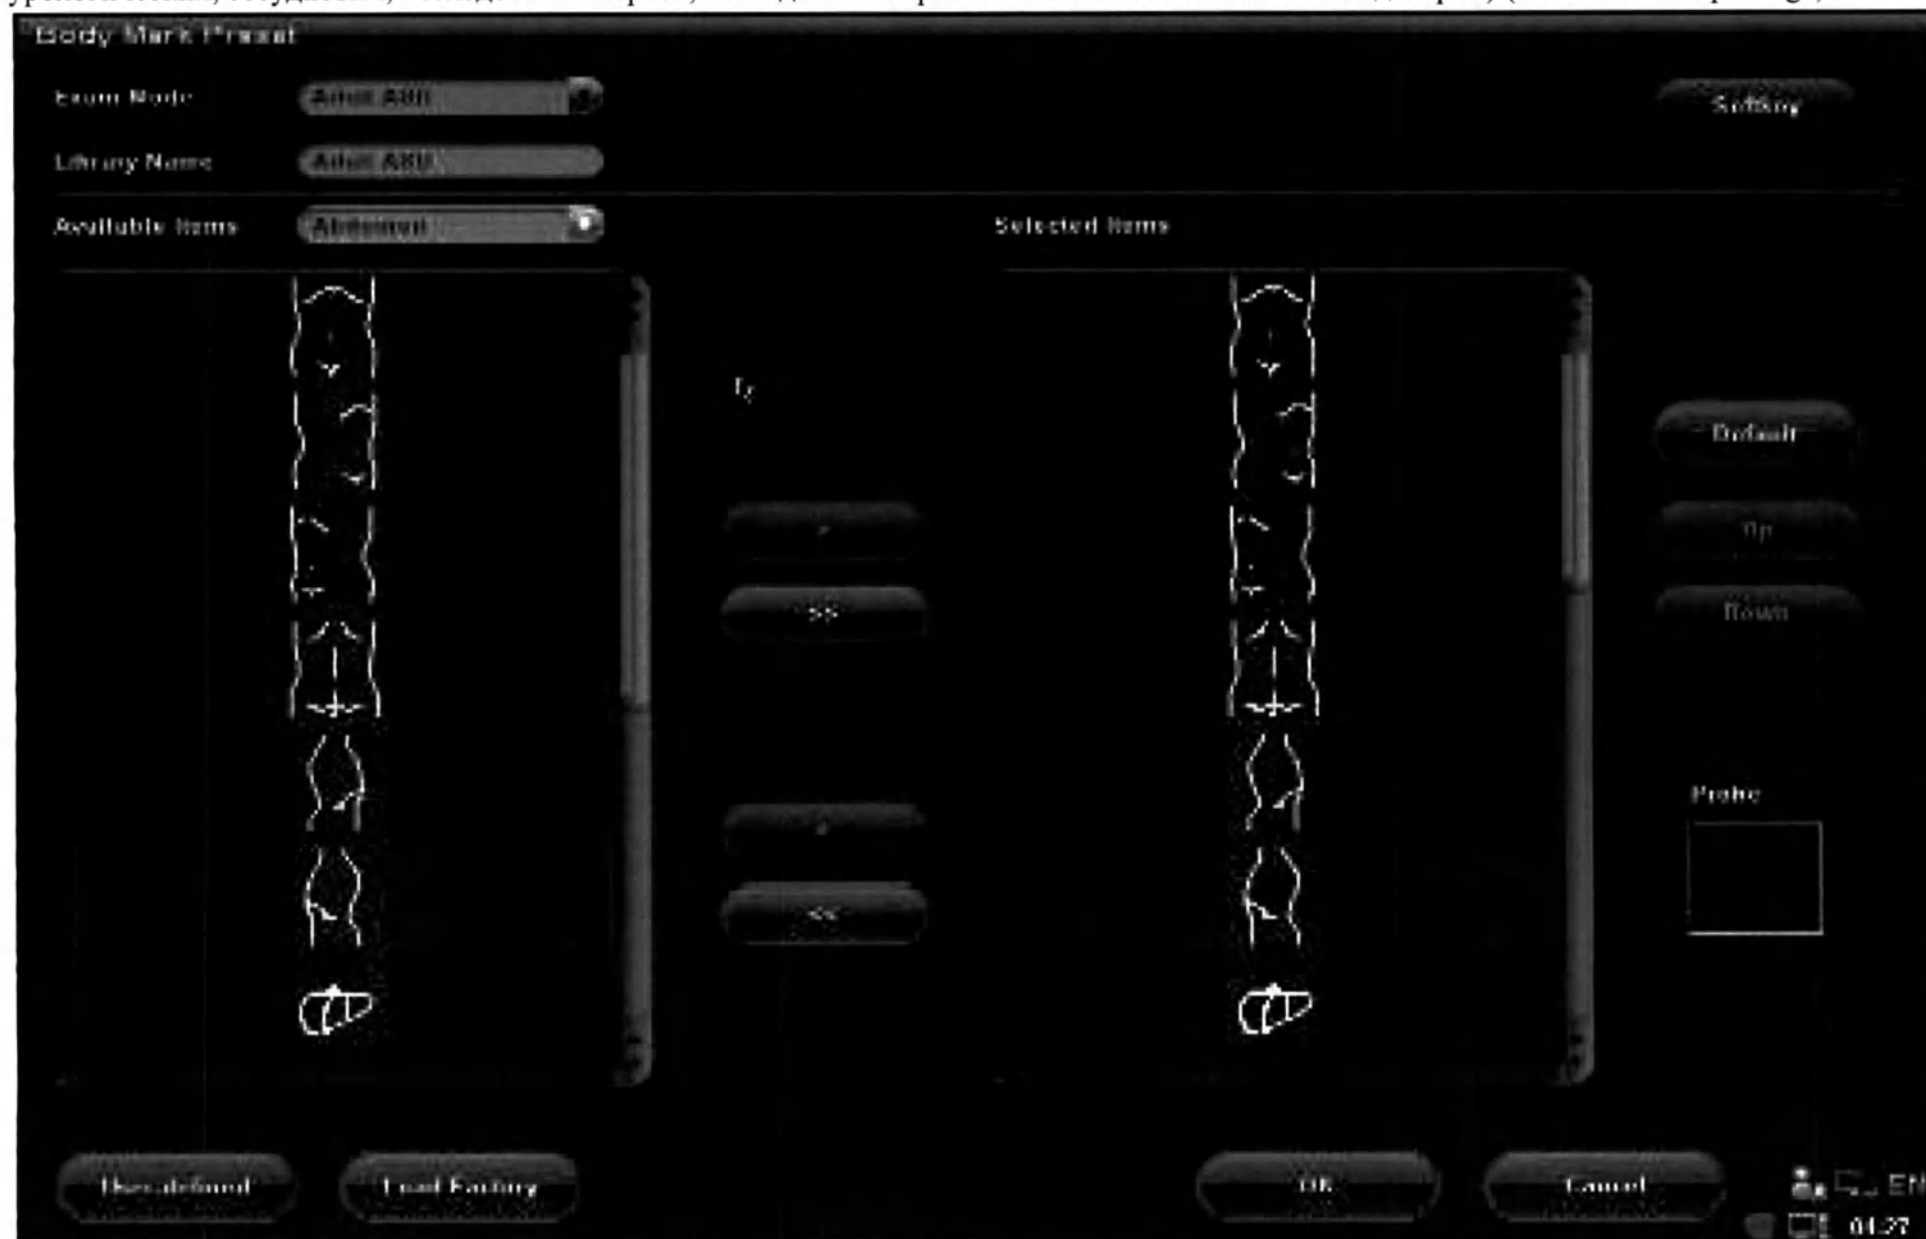





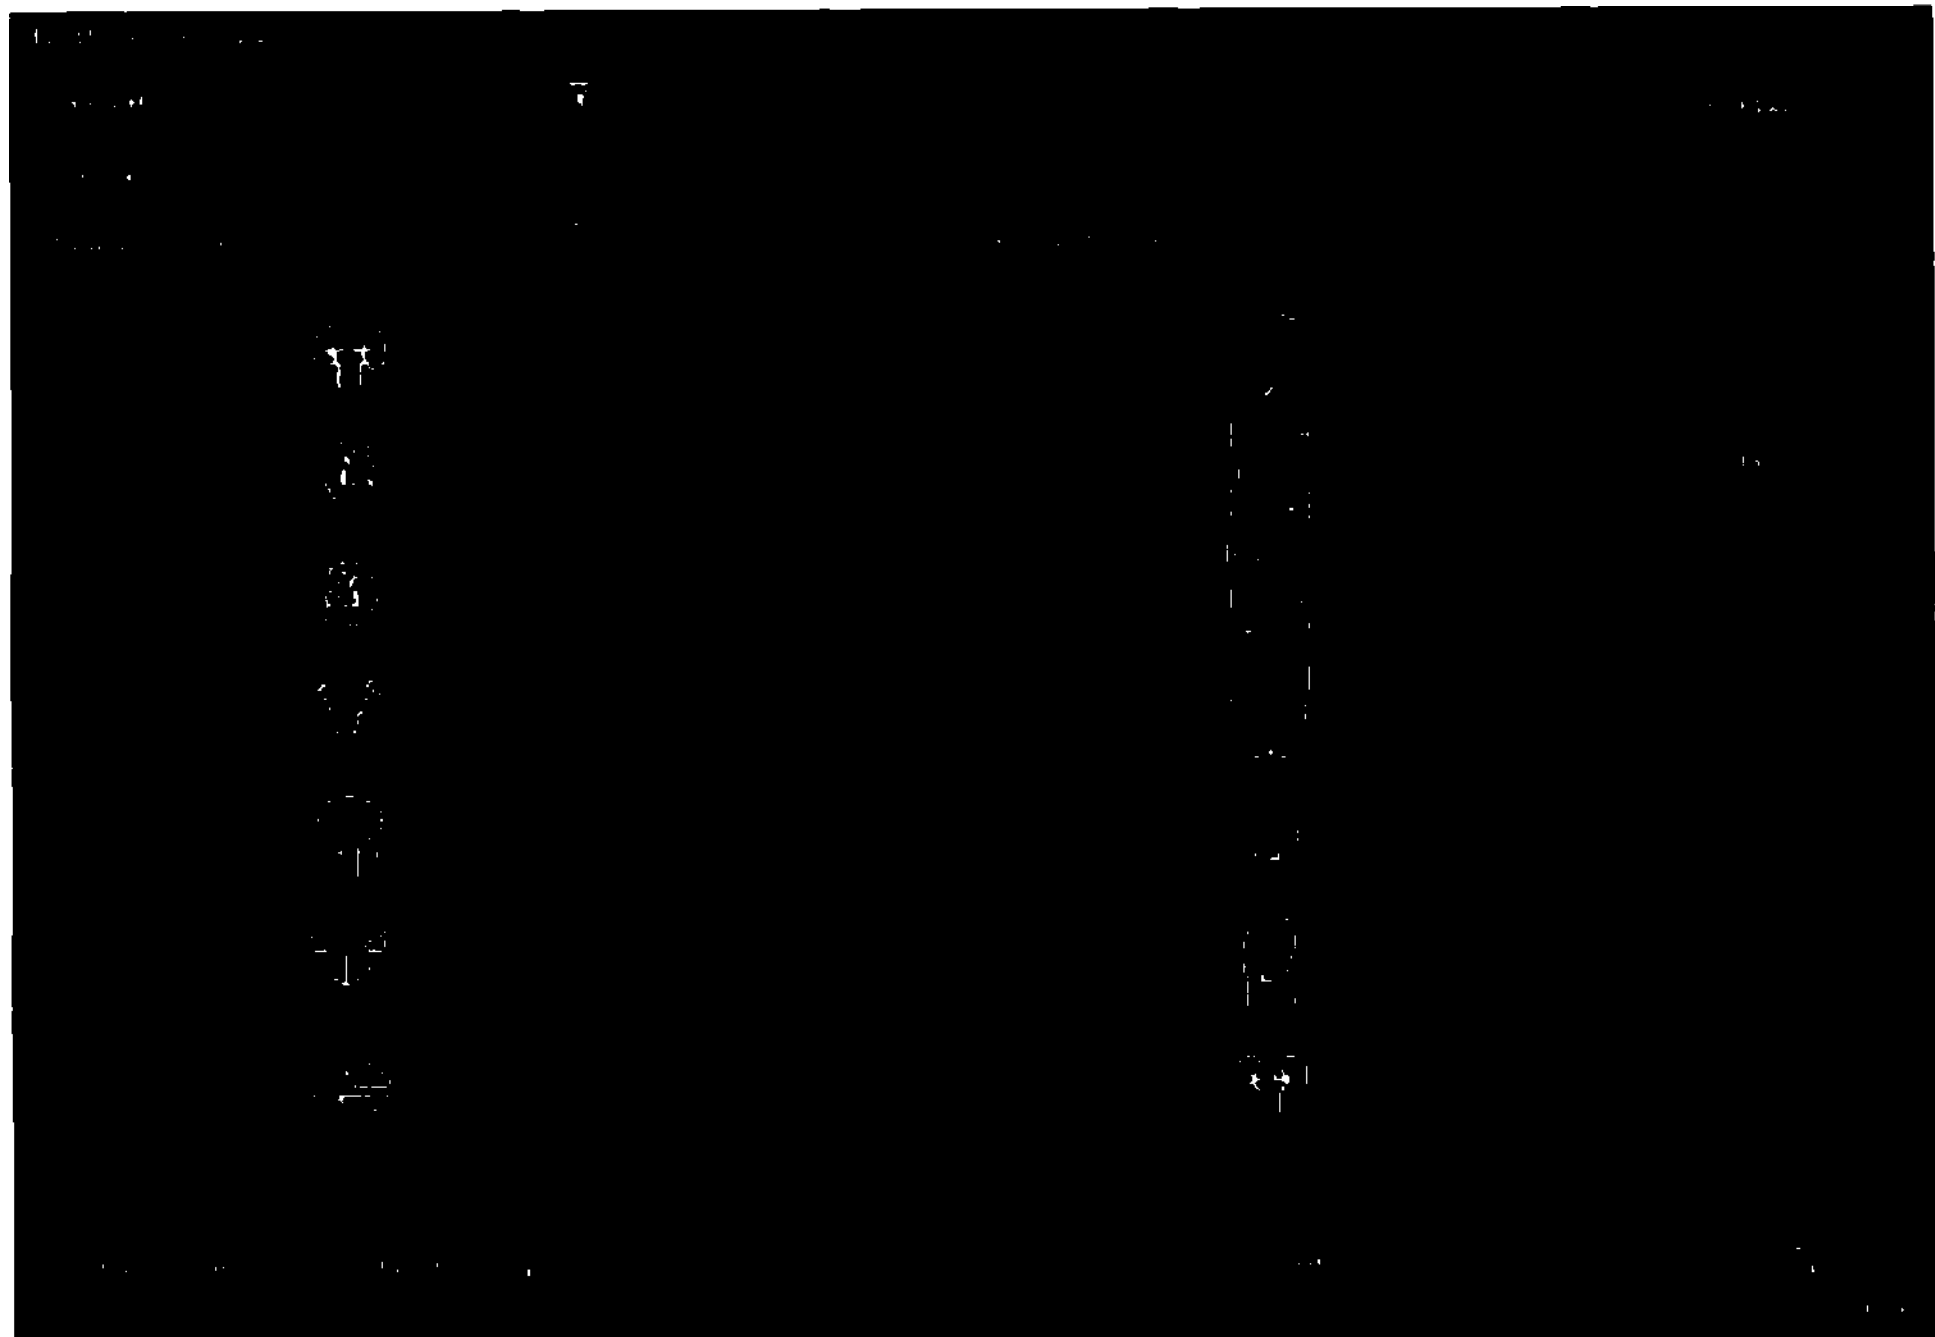

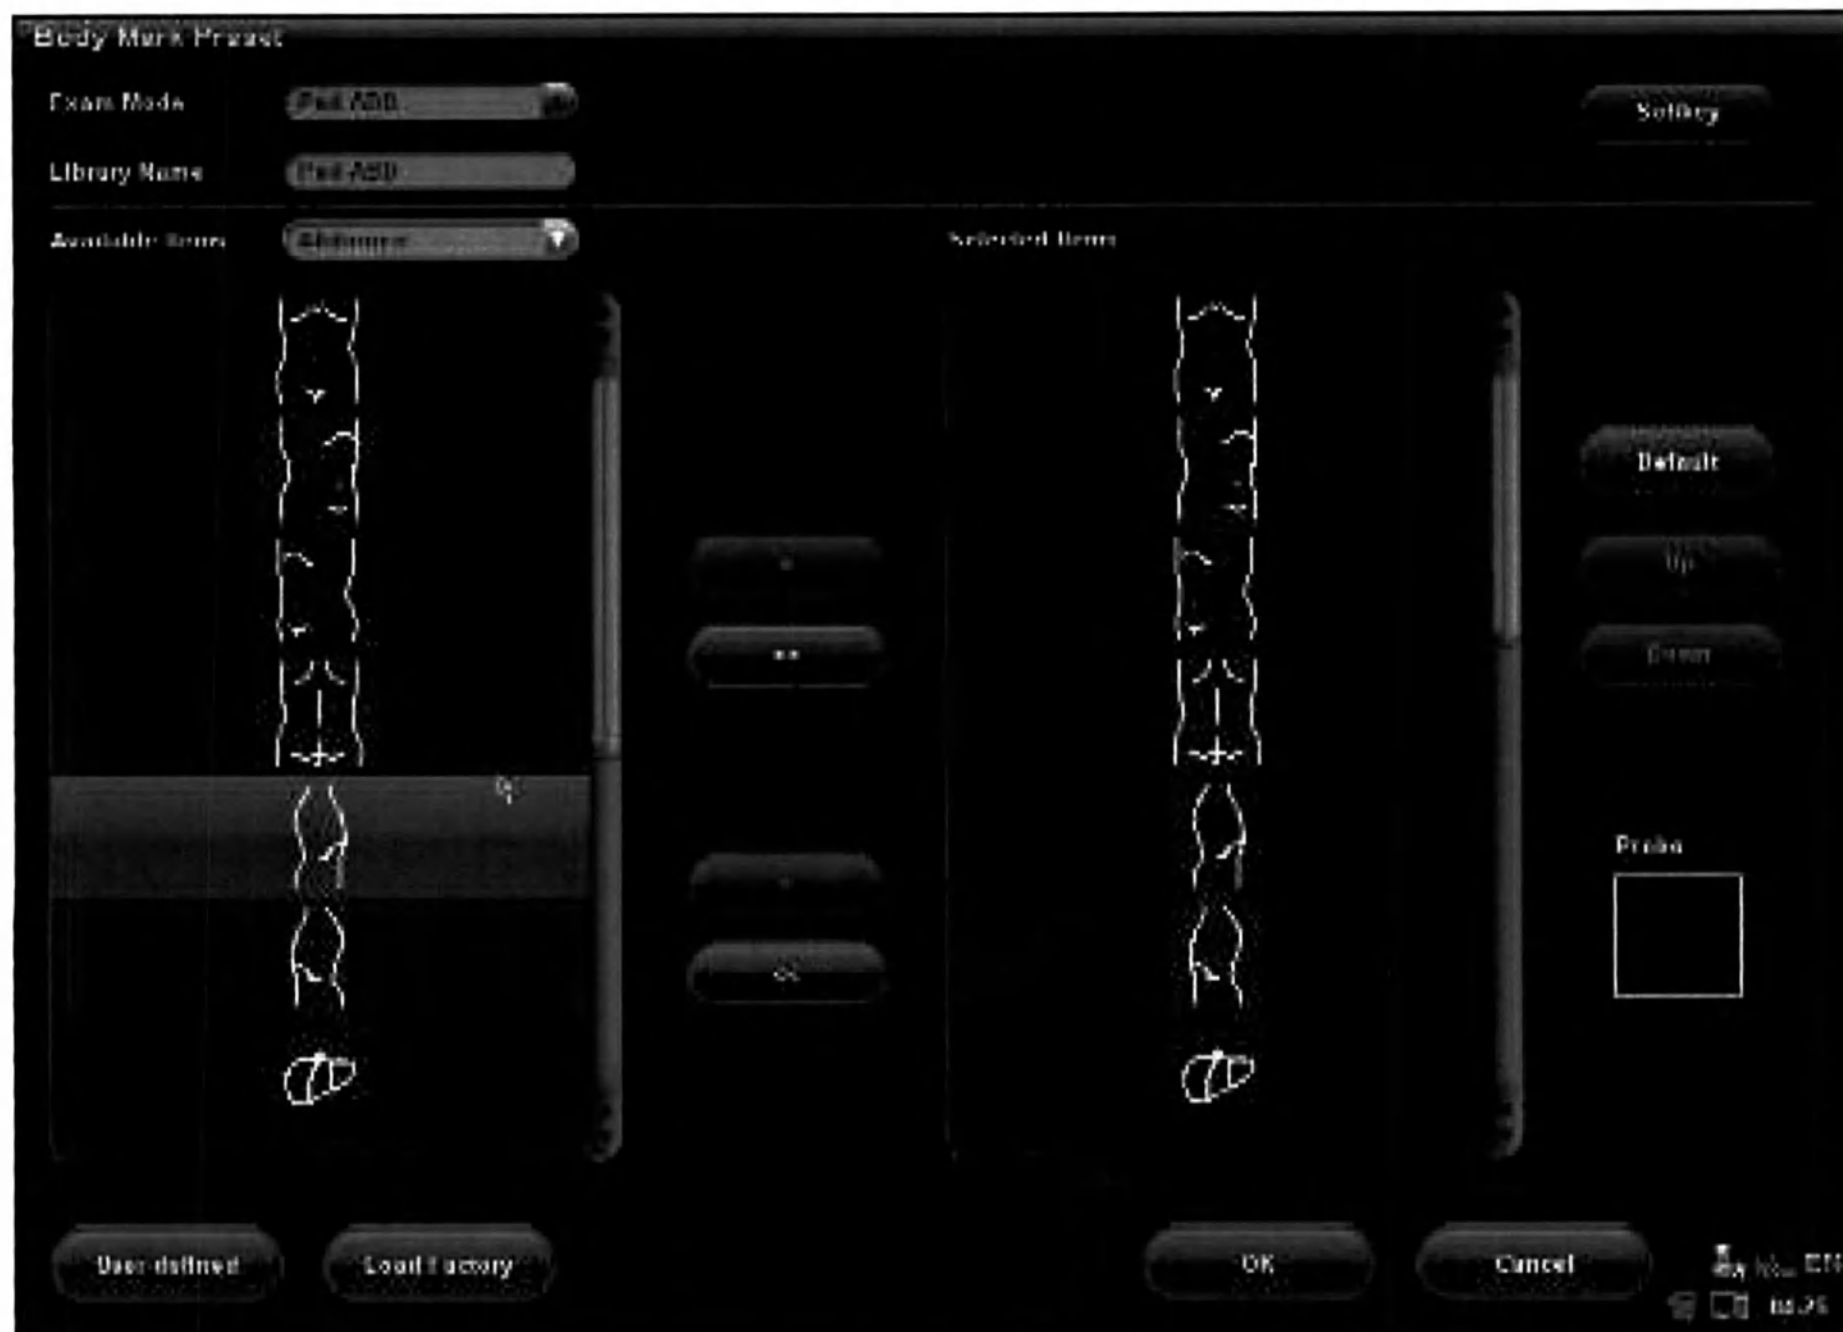





26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Storage		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Configure the New Service

Device: Service Name: AI Title: Port:

TimeoutSec:

Scheduled Station AI Title:

Add Cancel

Service List

	Device	Service Name	AI Title	Port	Default
1	12	12 Worklist		101	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage Print Worklist **MPPS** Storage Commitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device Service Name AE Title Port

Maximum Retries Interval Time(Sec) Timeout(Sec)

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 03:37

26.15. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-QueryRetrie

AE Title

Port

104

Maximum Retries

1

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-QueryRetrieve		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-Storage

AE Title

Port

104

Maximum Retries

3

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Cine Zoom Mode

Original

Compression Mode

RLE

Compression Ratio

Lossless

Color Mode

Color

☒ Allow Multiframe

Max Framerate

35

SR Storage Option

Not Store SR

Attach SR When Store Images

Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements

Only Store SR

Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Not Store SR

12-Storage

Add

Cancel

Service List

	Device		Default
1	12		N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

Exit

EN

02:33

26.17. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
☒ Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option

Add
Cancel
Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements
Not Store SR
12-Storage
104
N

Service List

	Device		Default
1	12		

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel

Service List


	Device		Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete Default Verify Verification is required!


Exit

EN 02:33


26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)

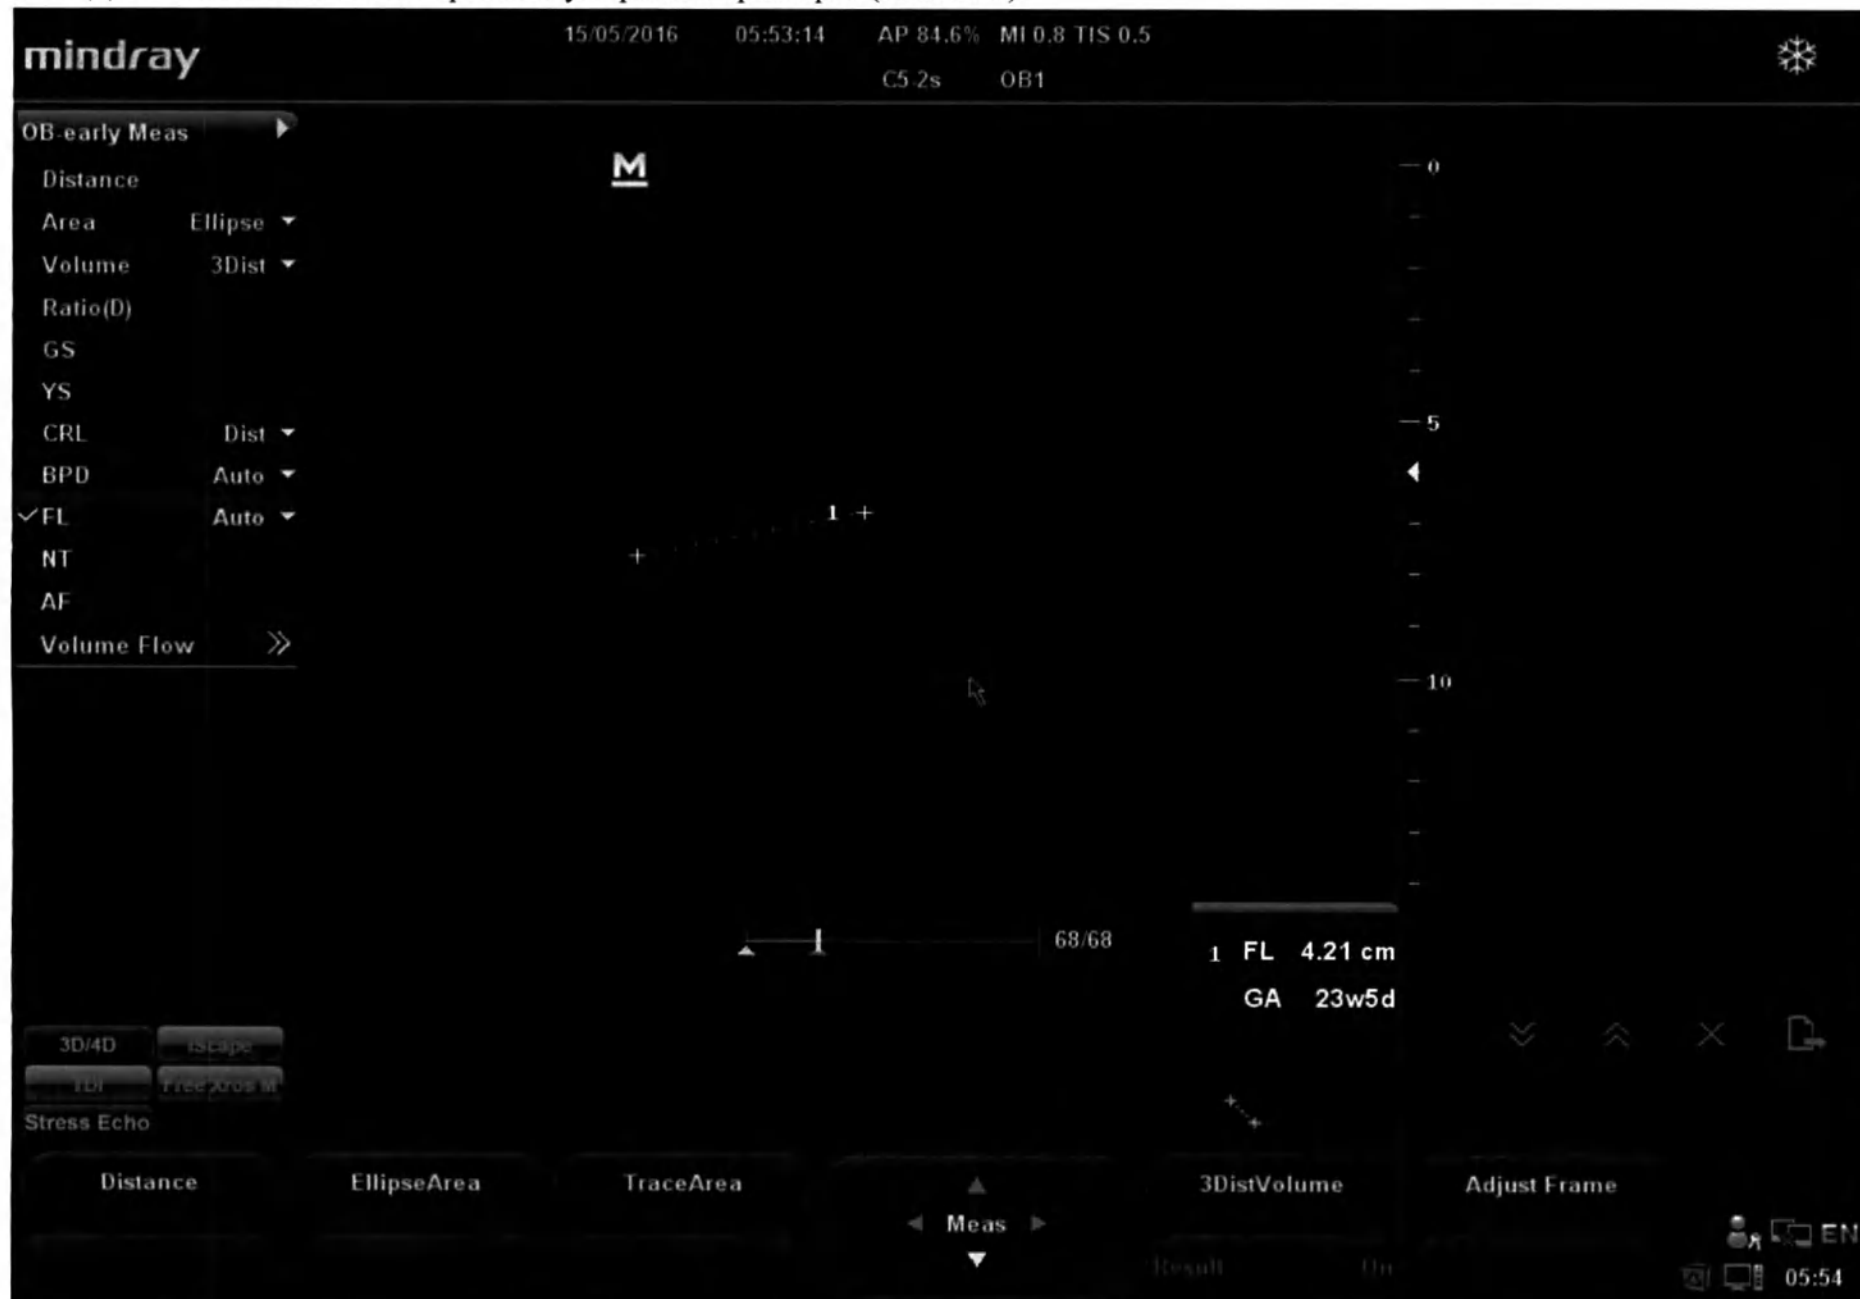


26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)

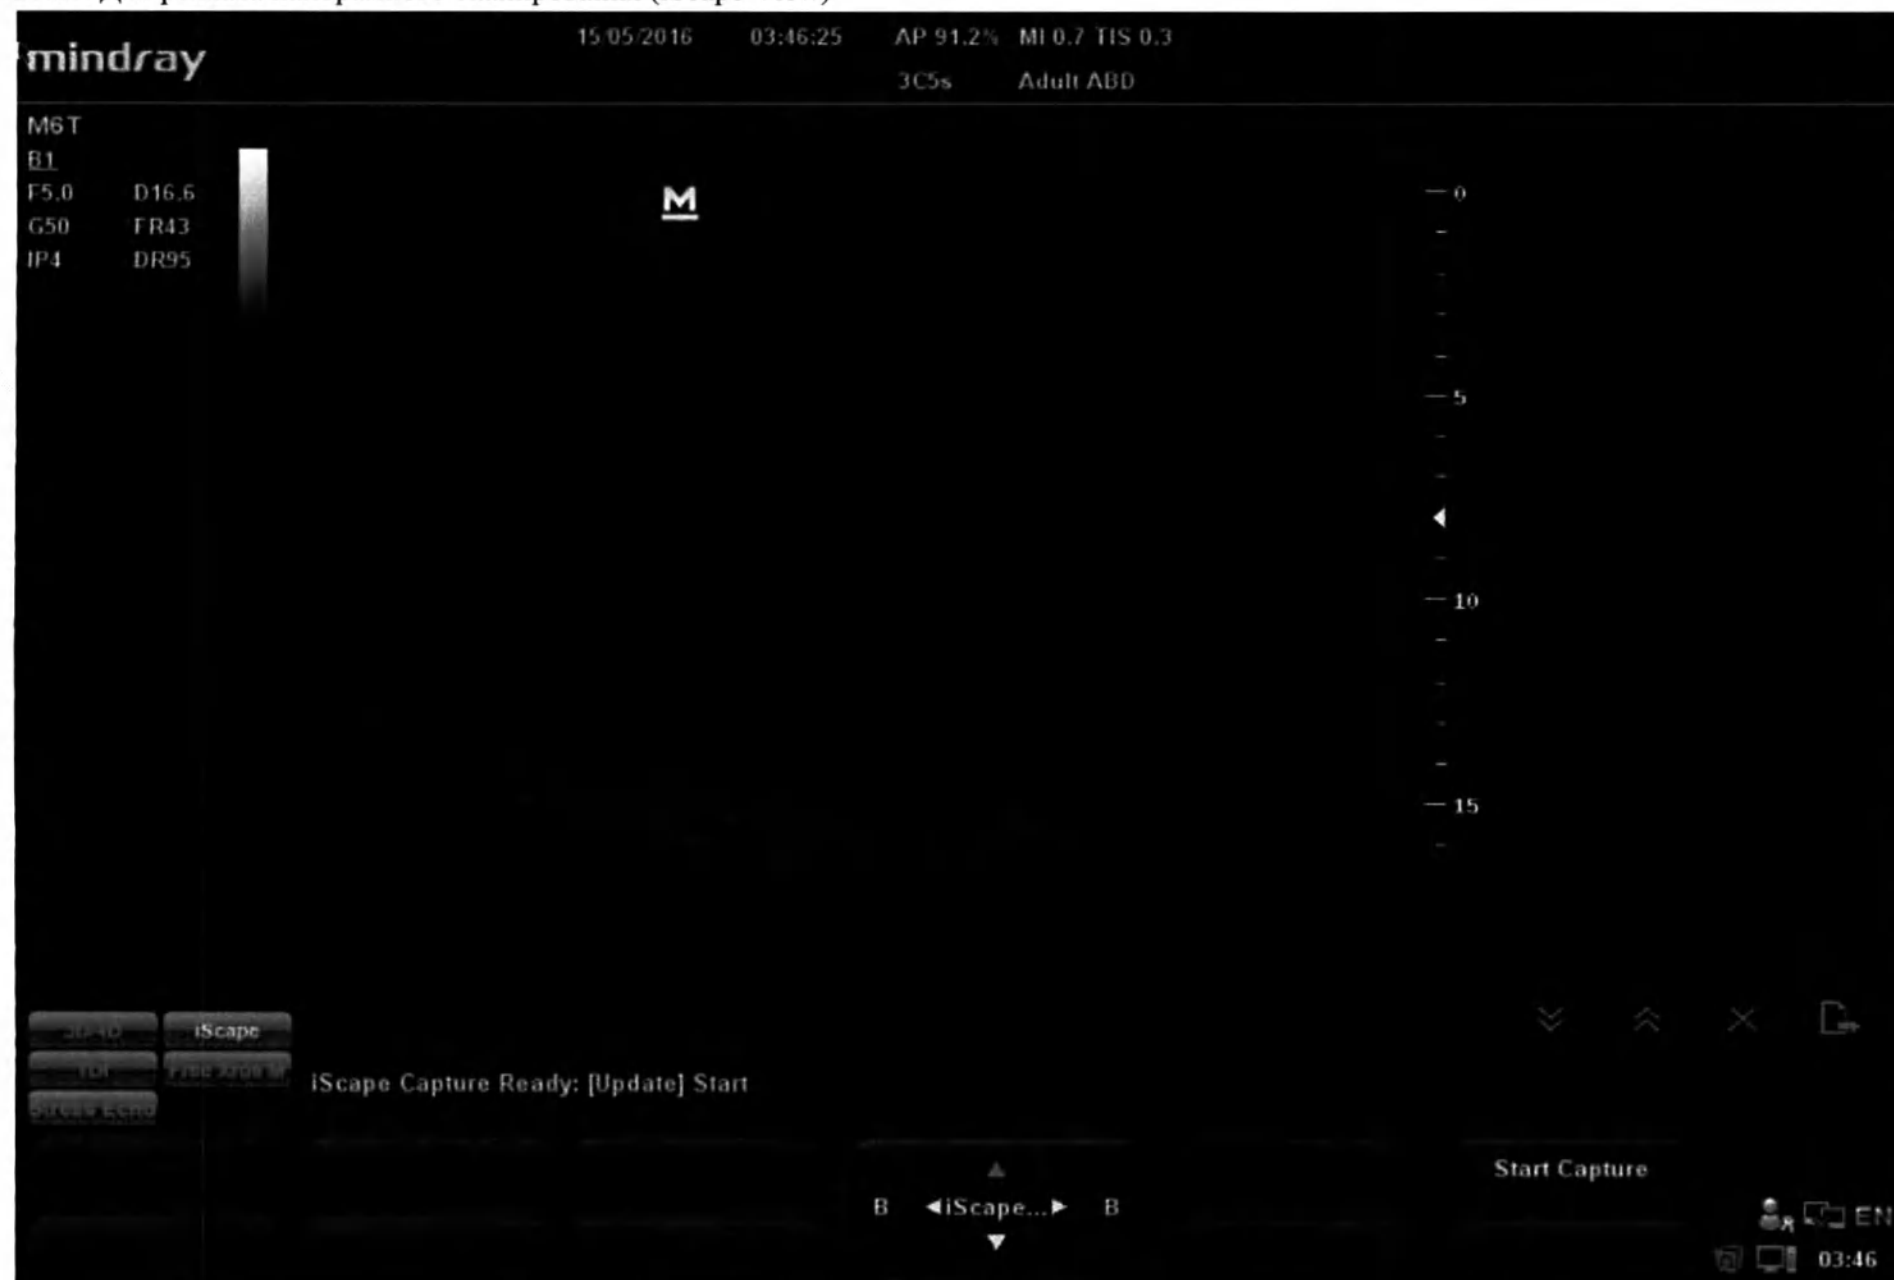


26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)

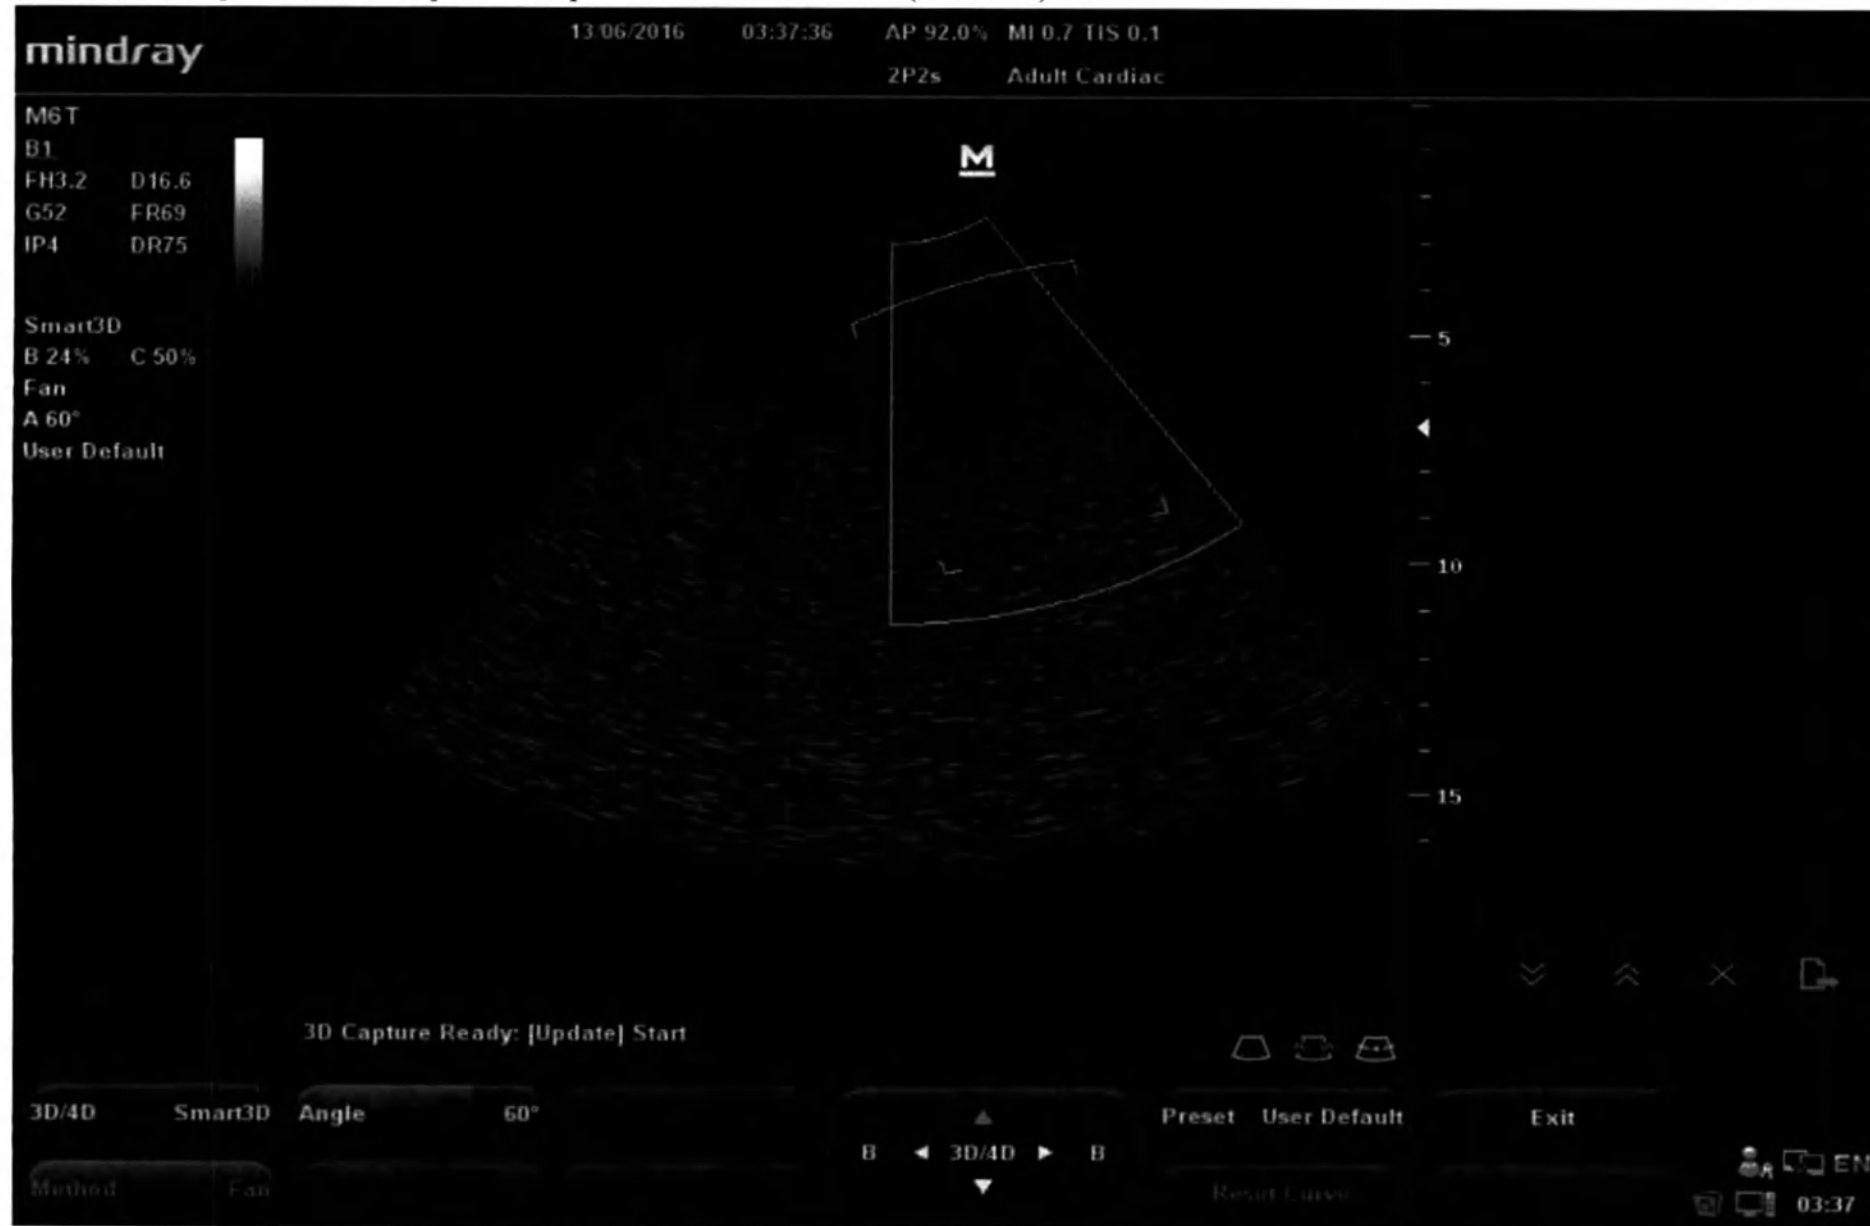


26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)

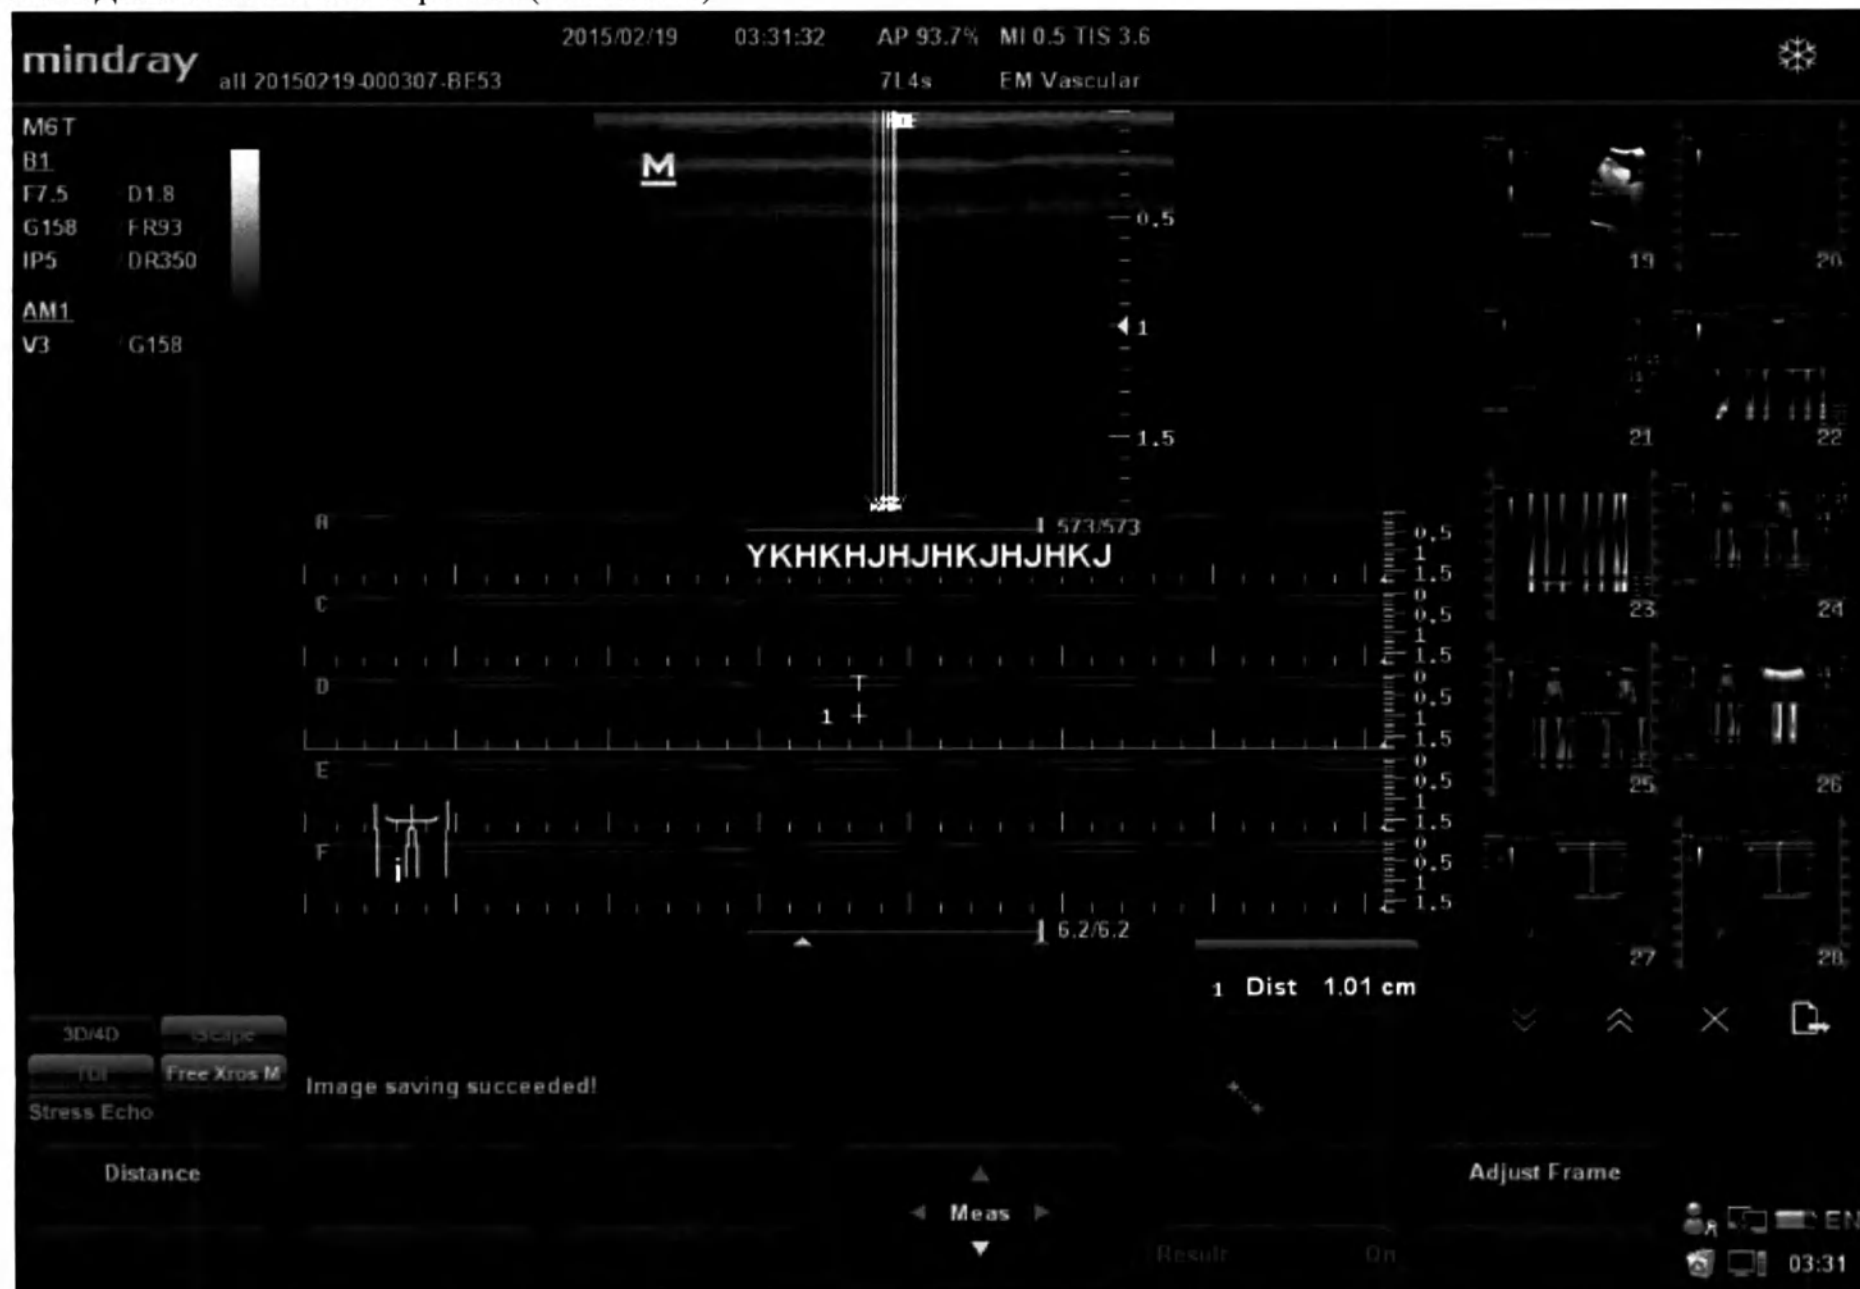

26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)

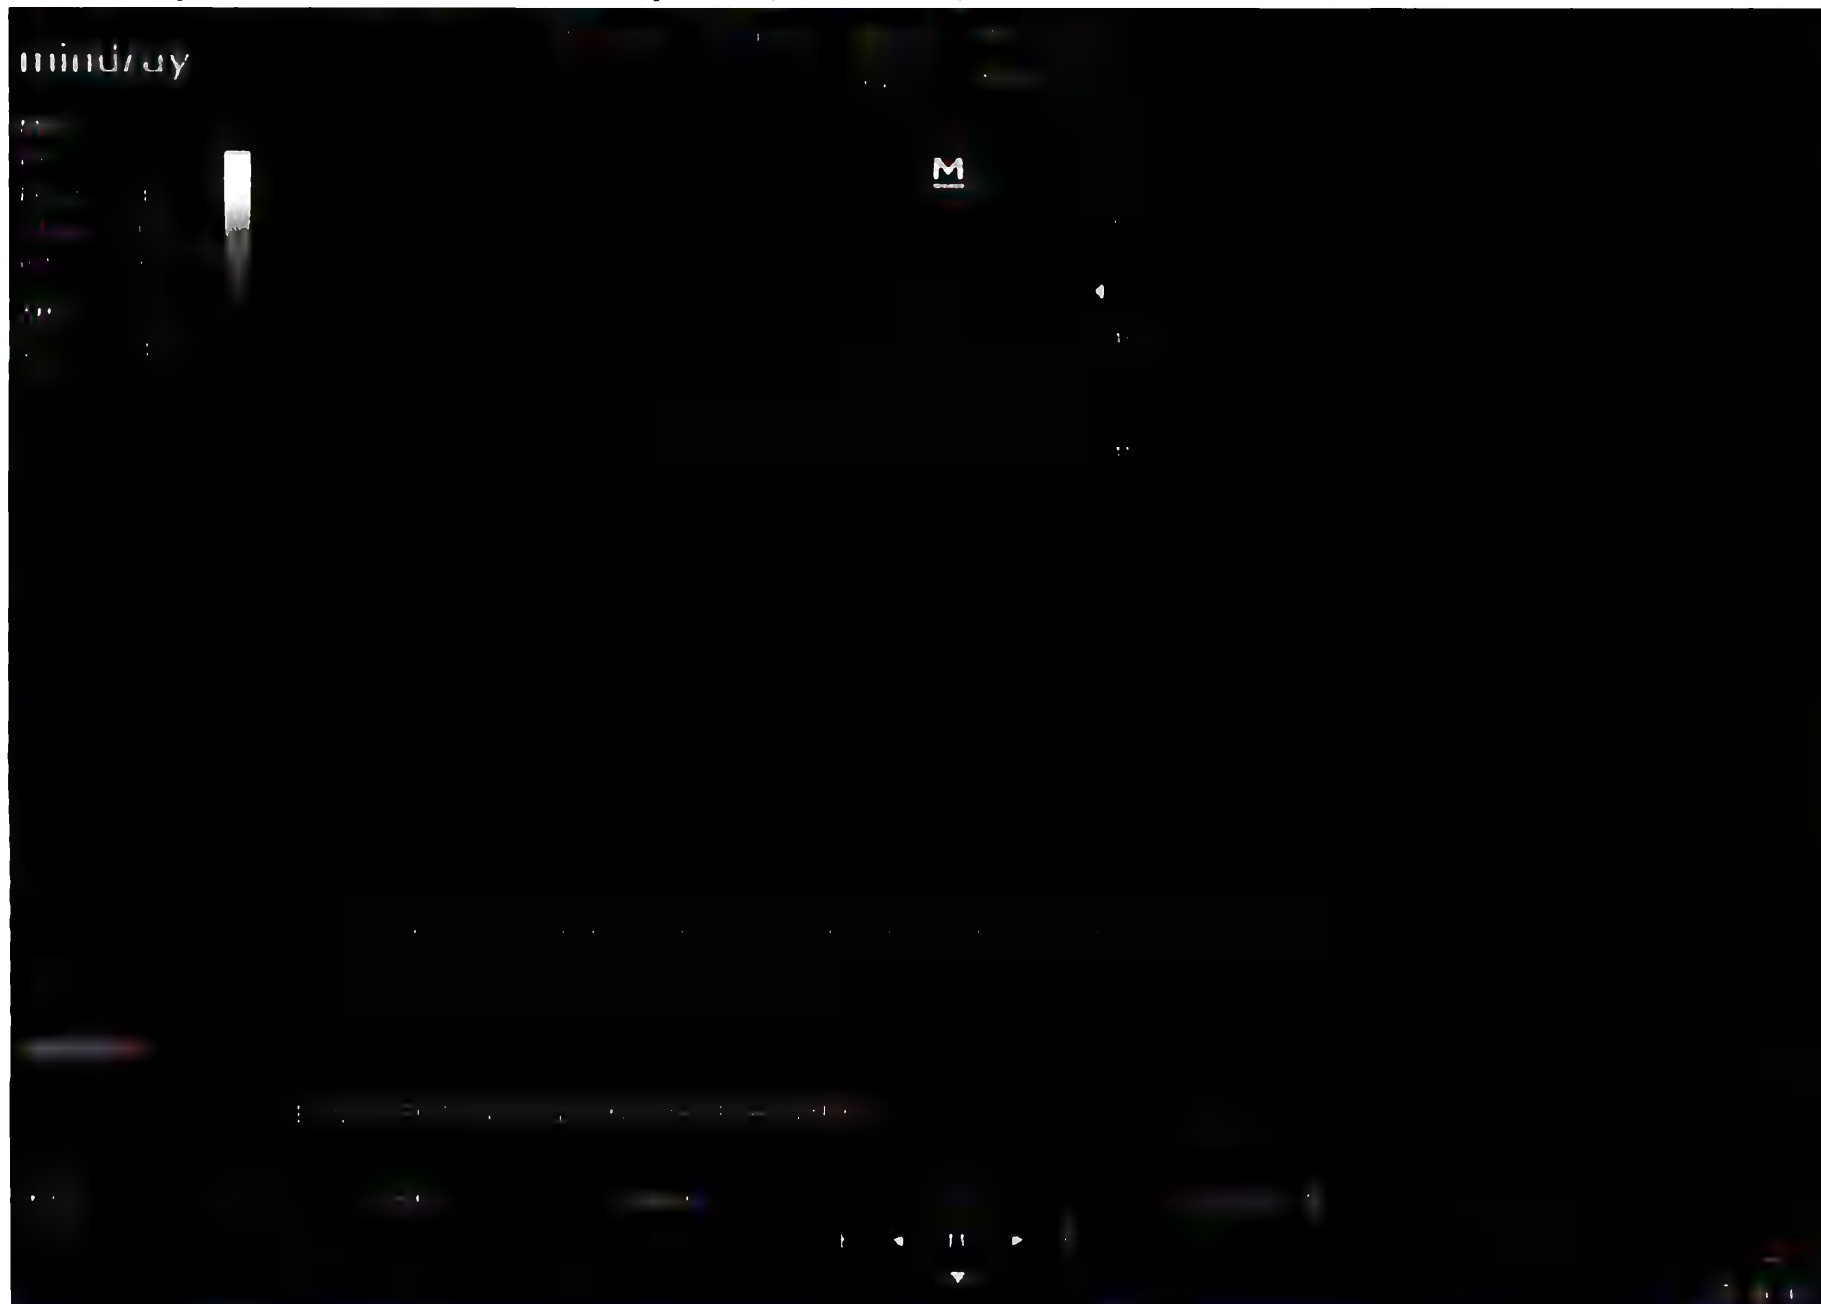

26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)

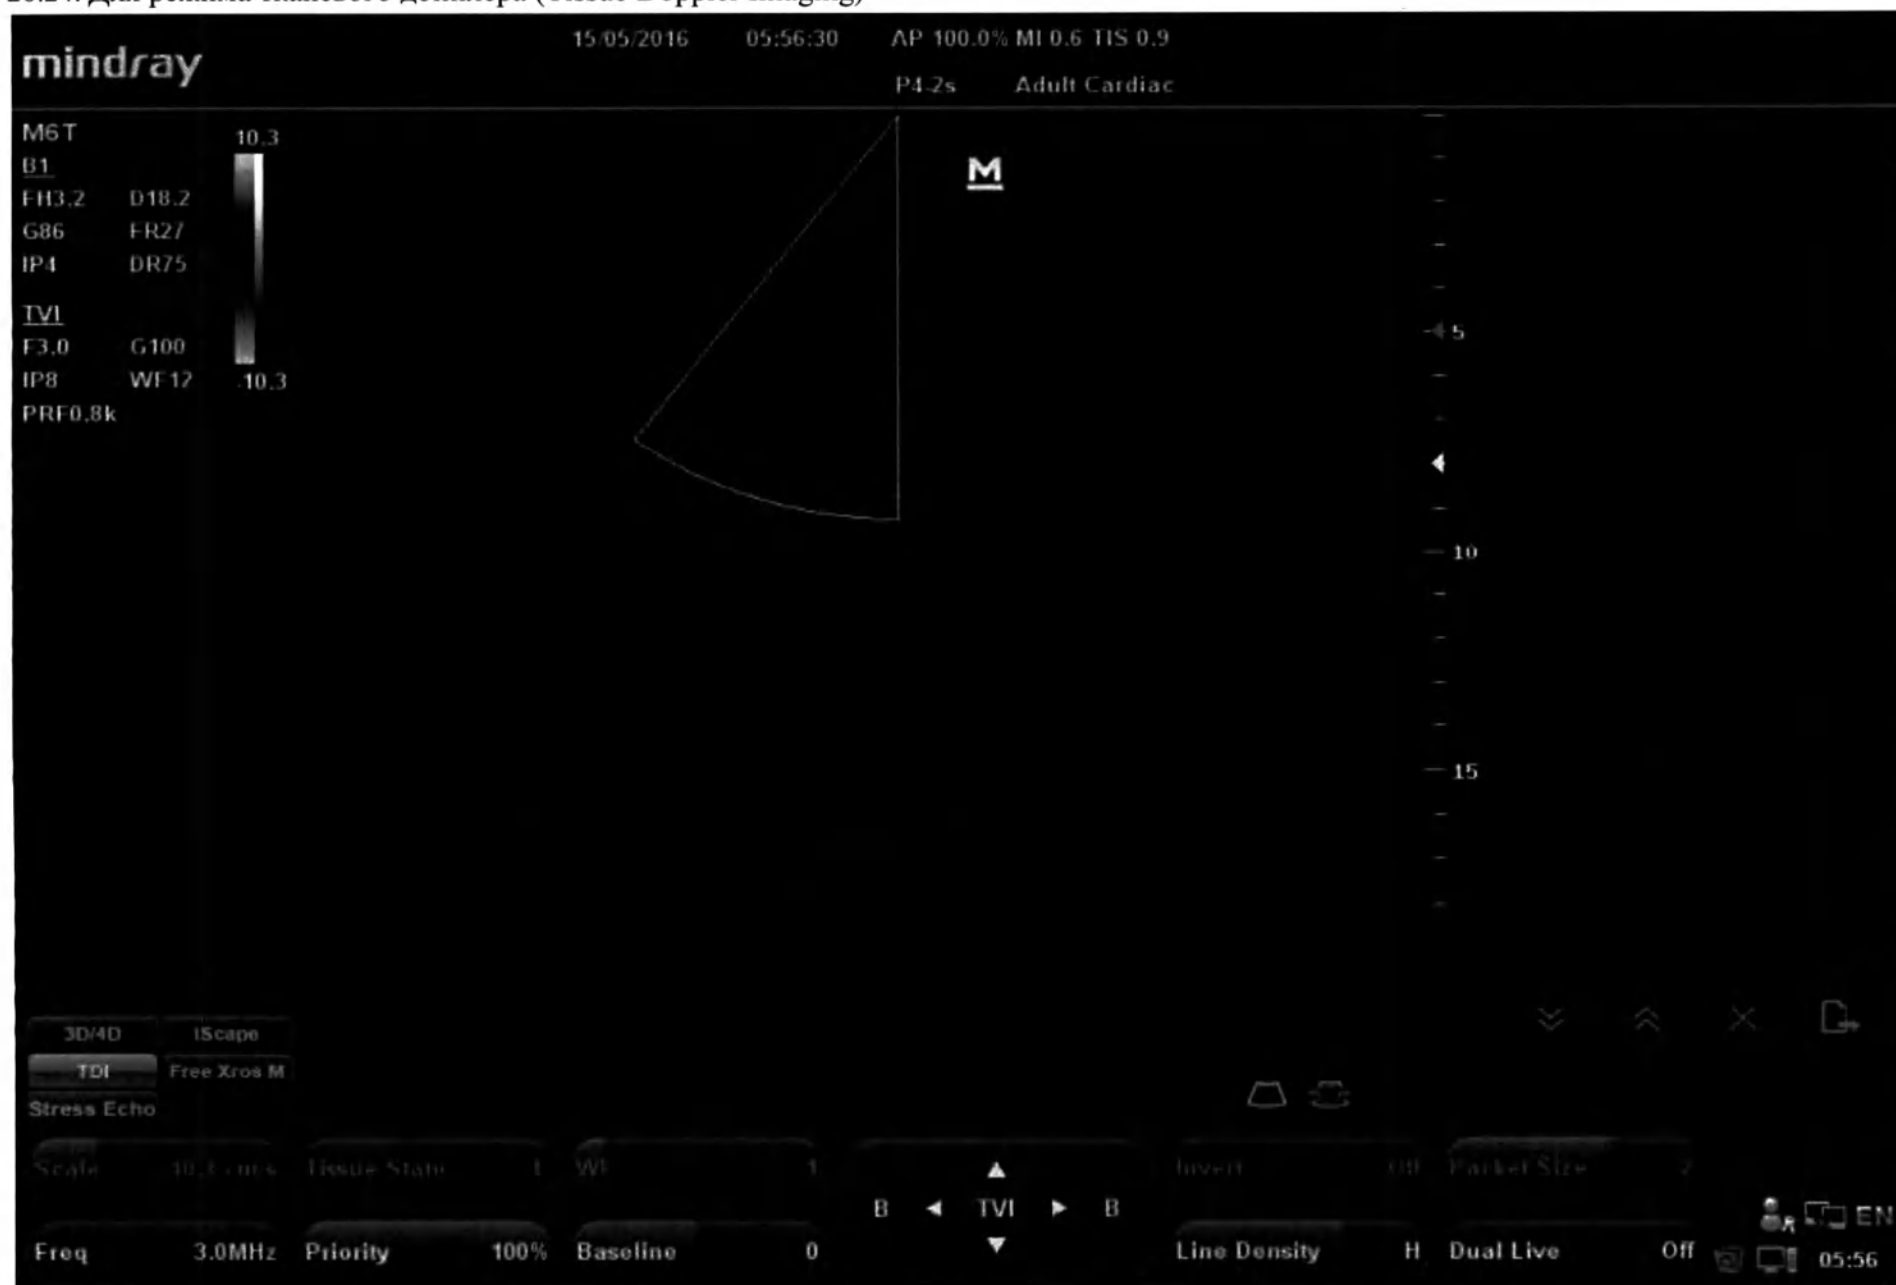


26.25. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)





26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)

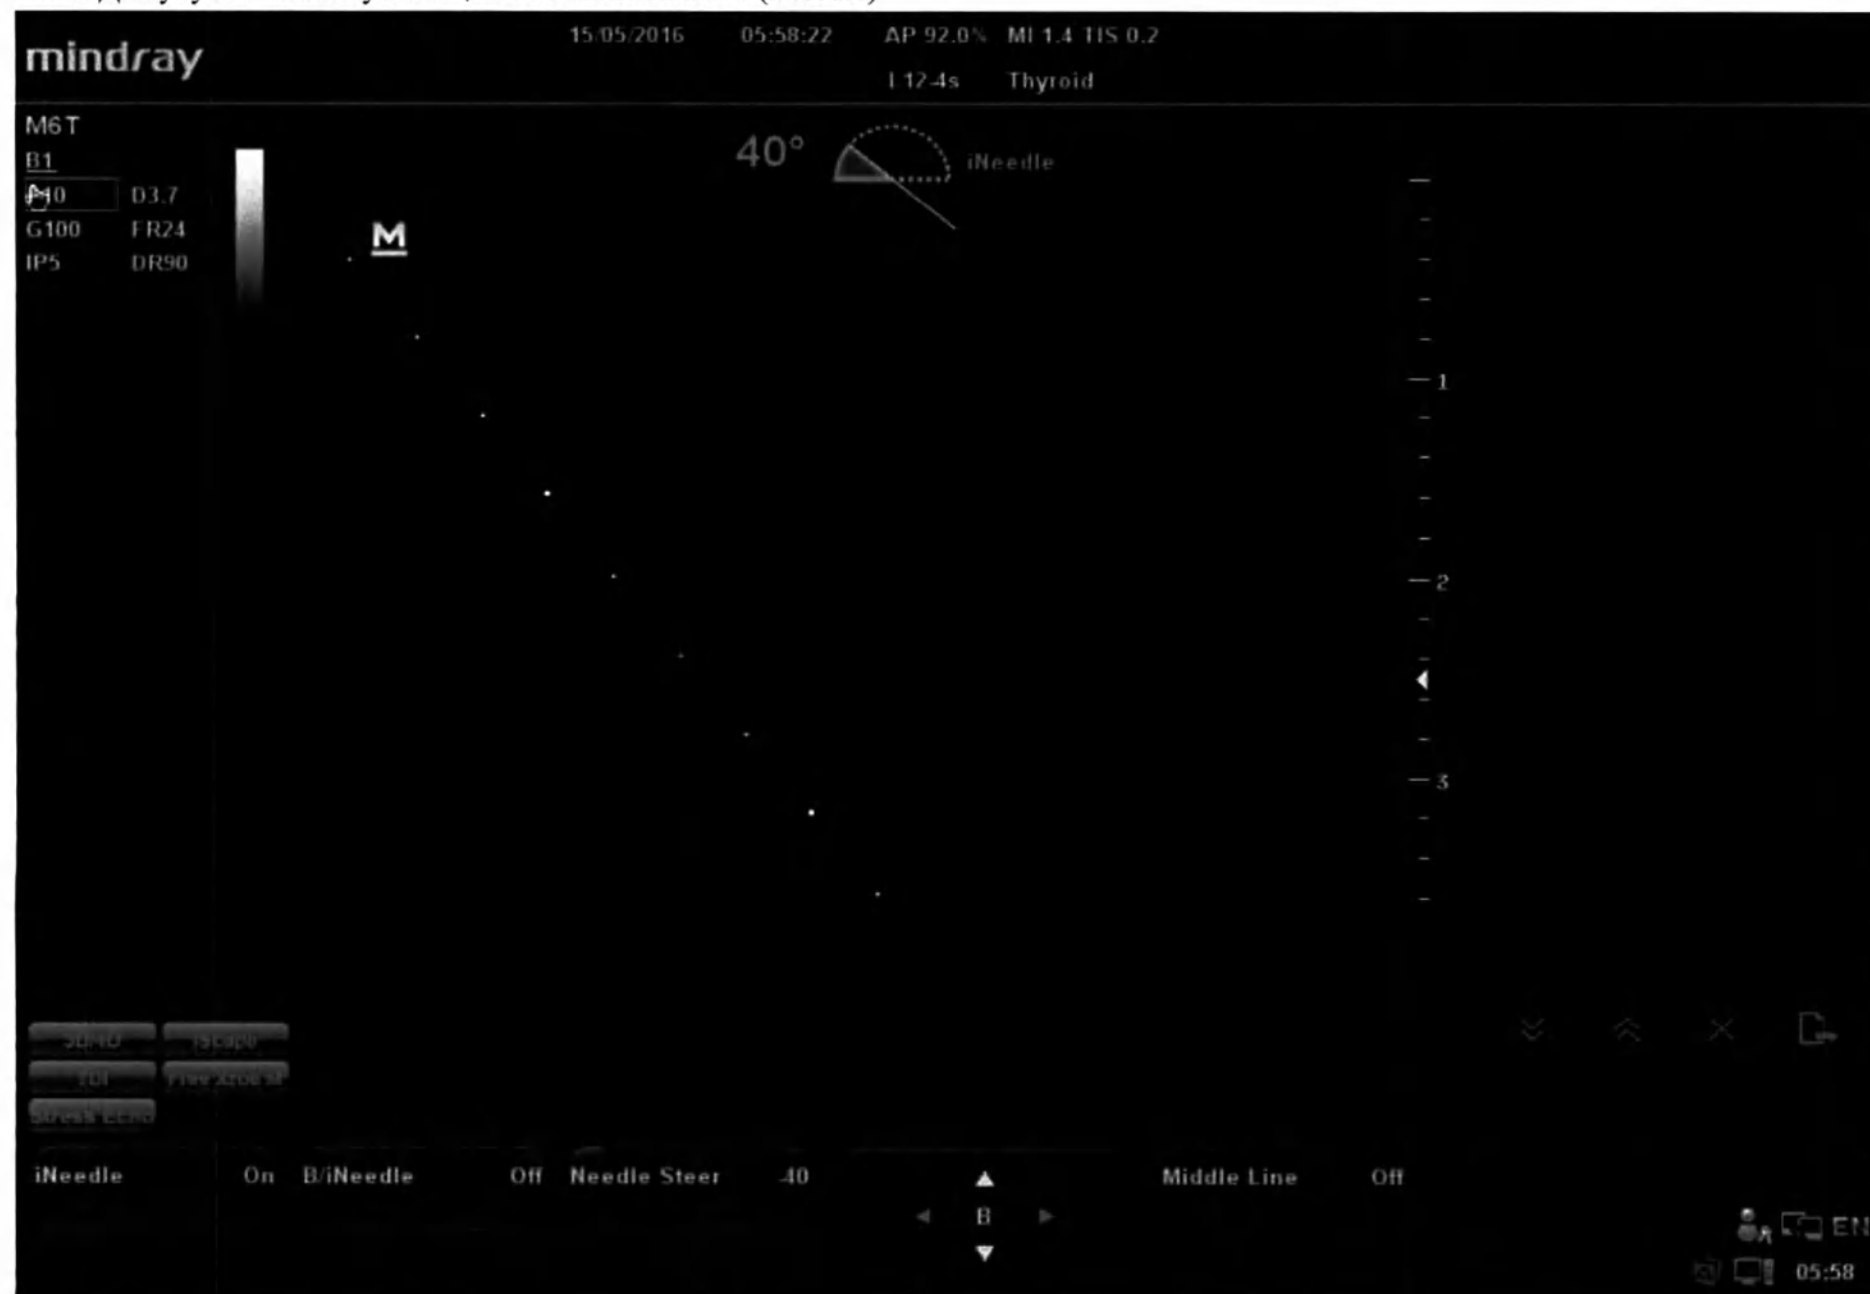


26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)




26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)



26.30. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

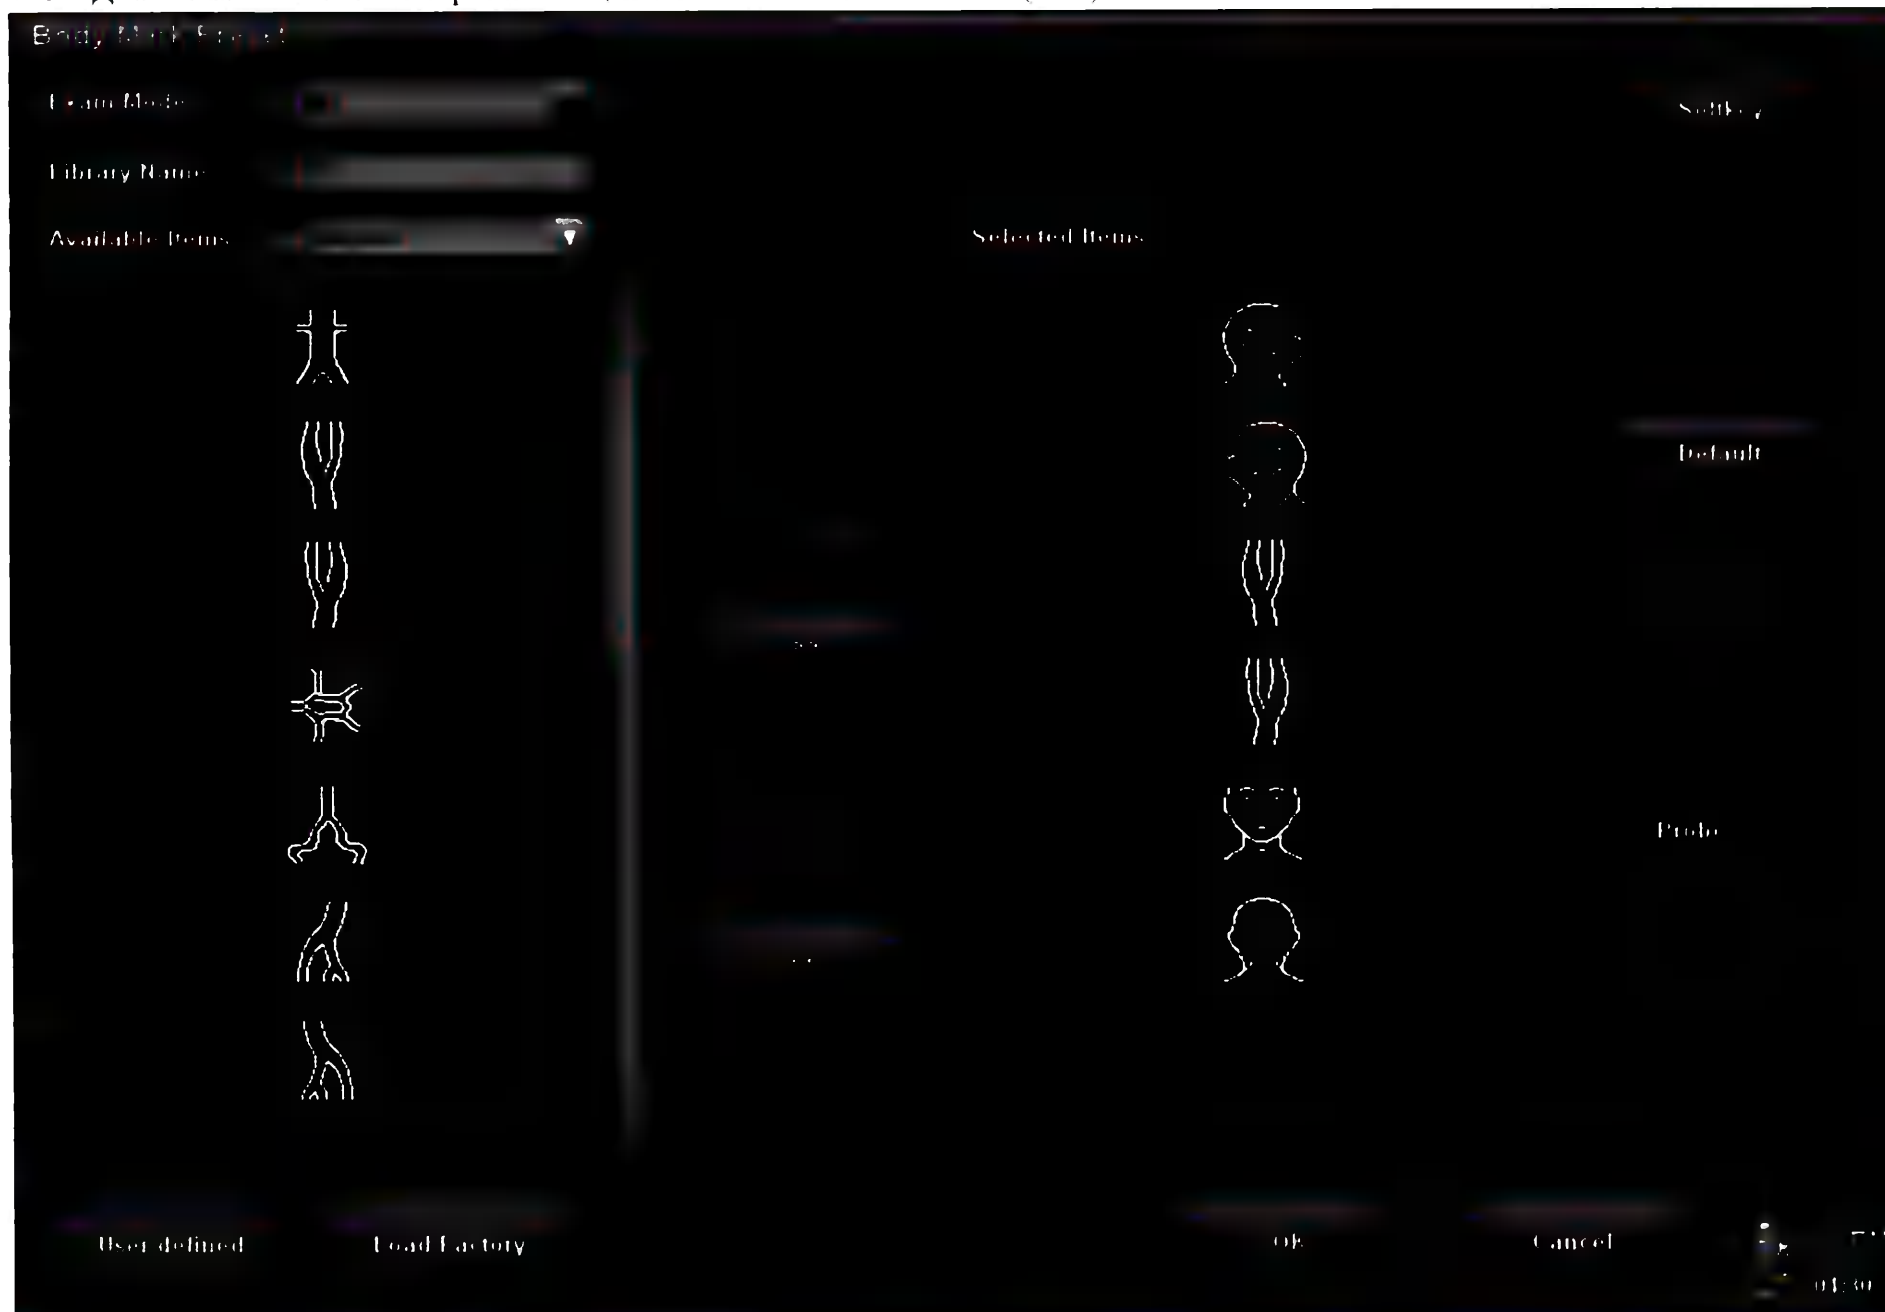



26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

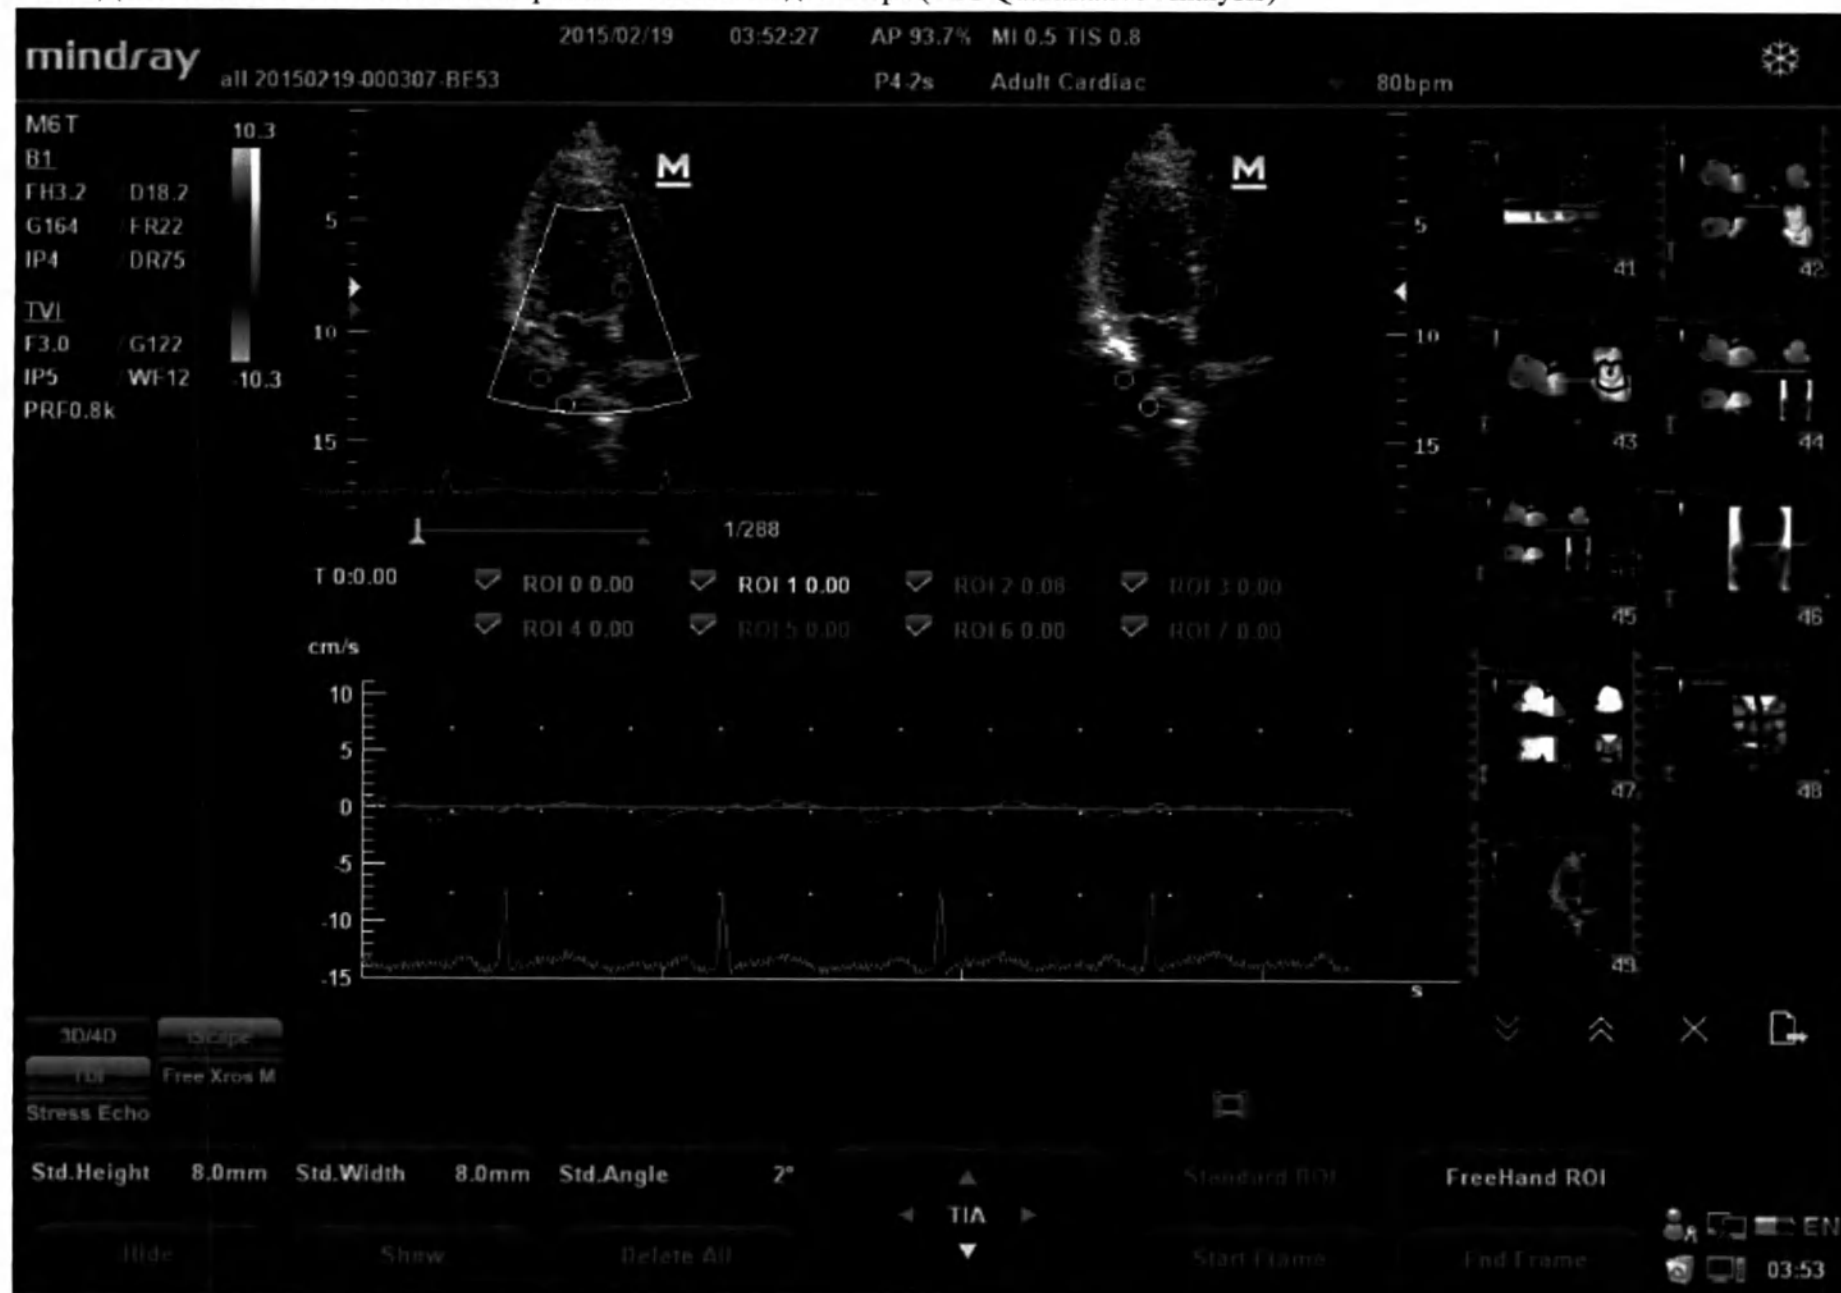



27. Модули:

27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

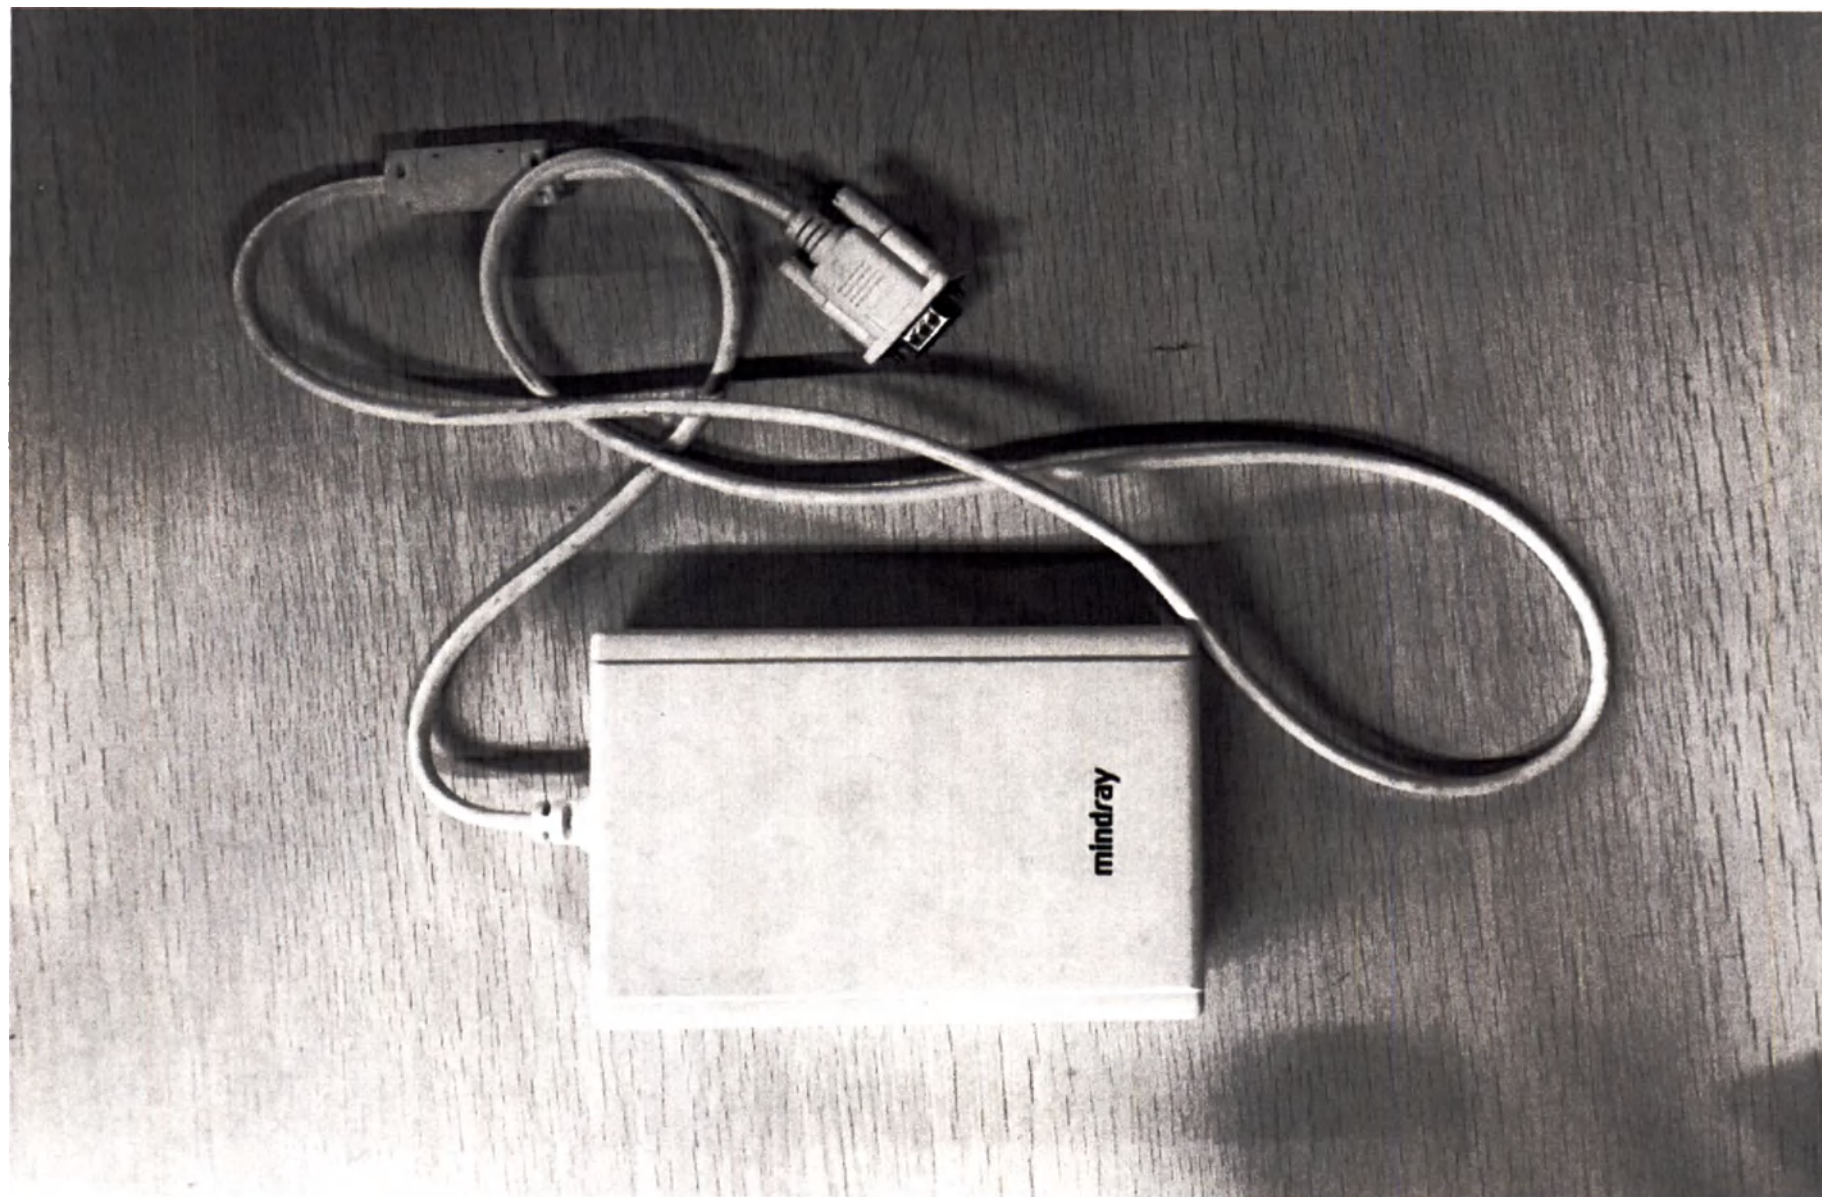


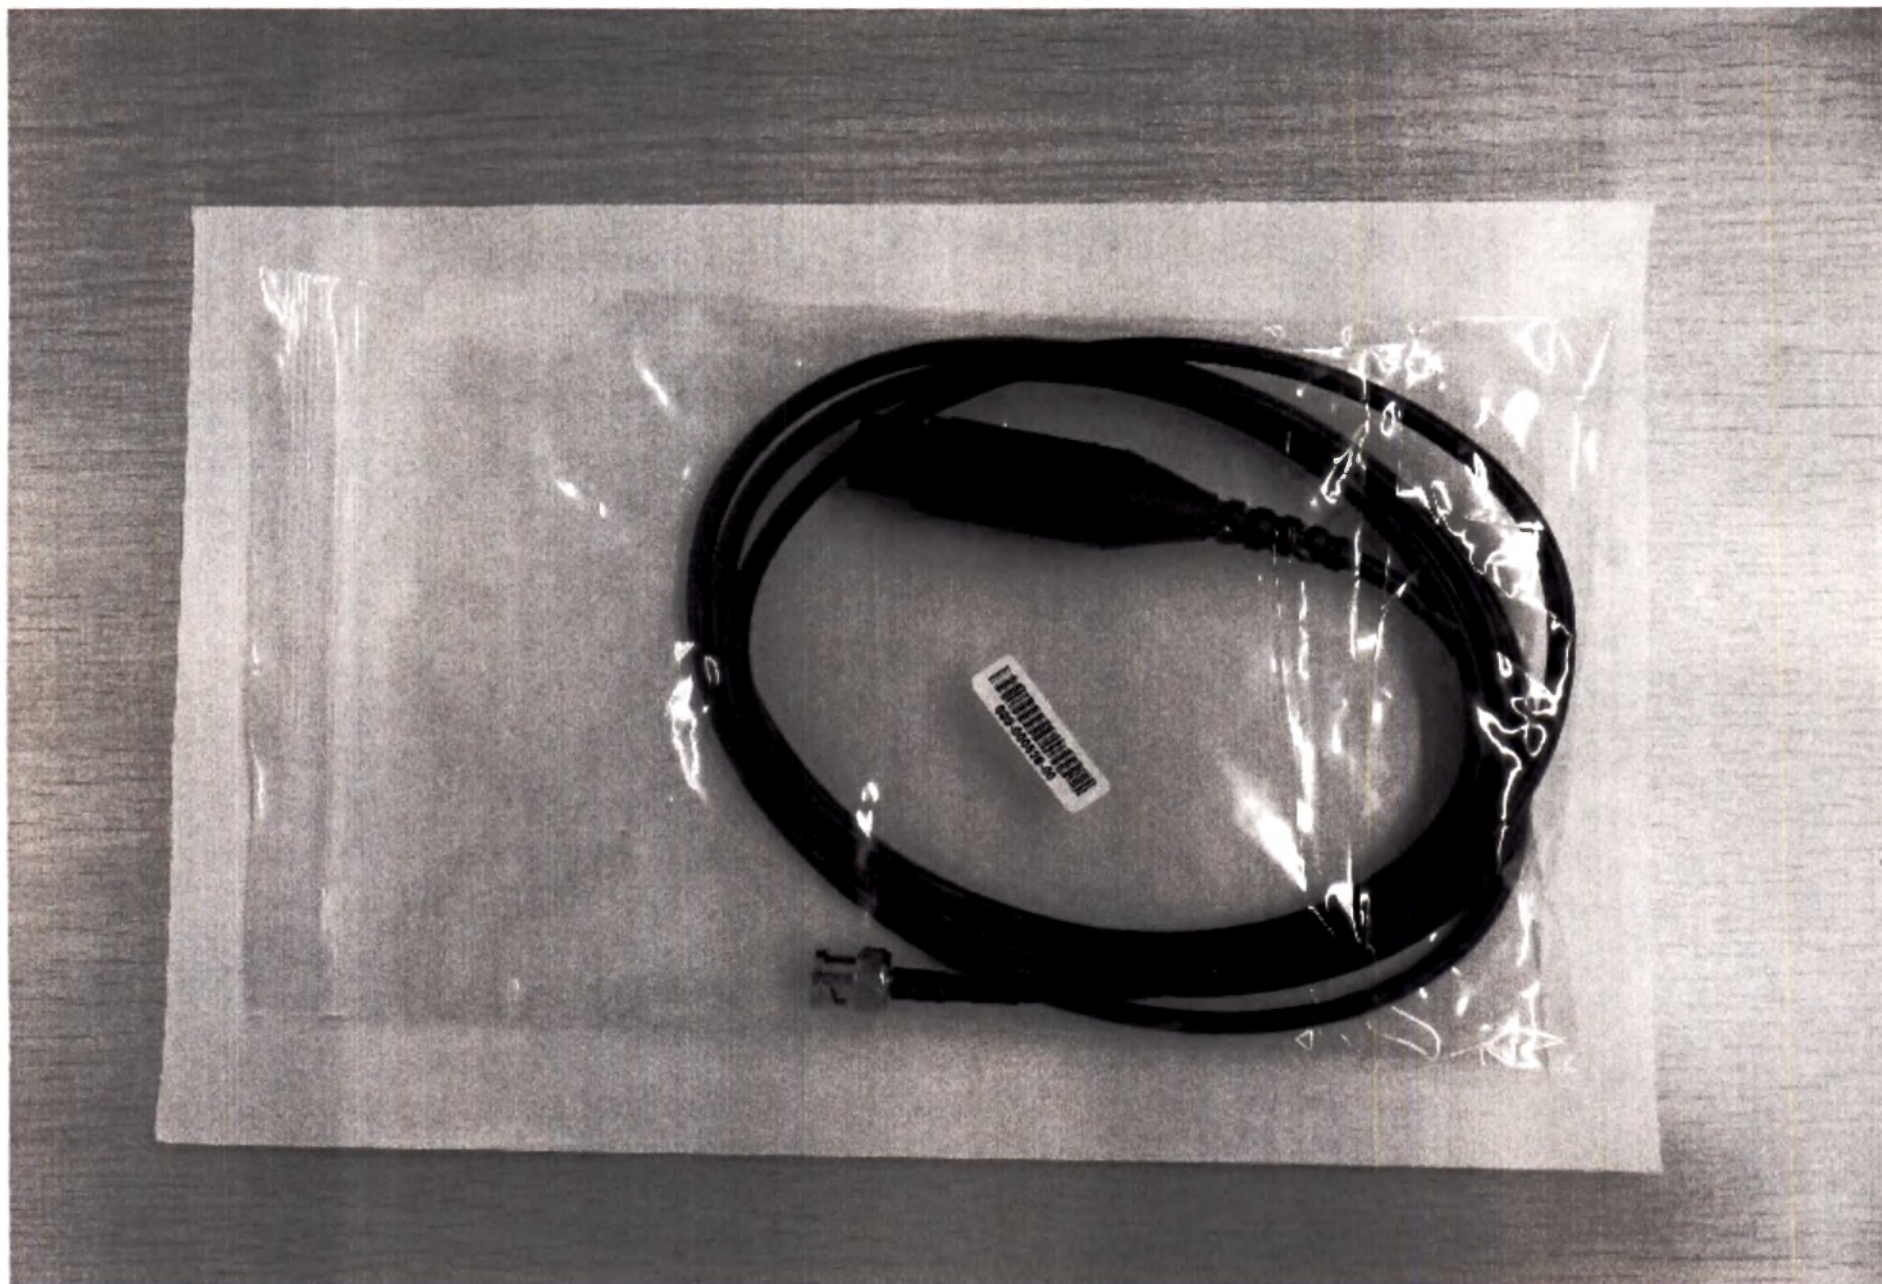

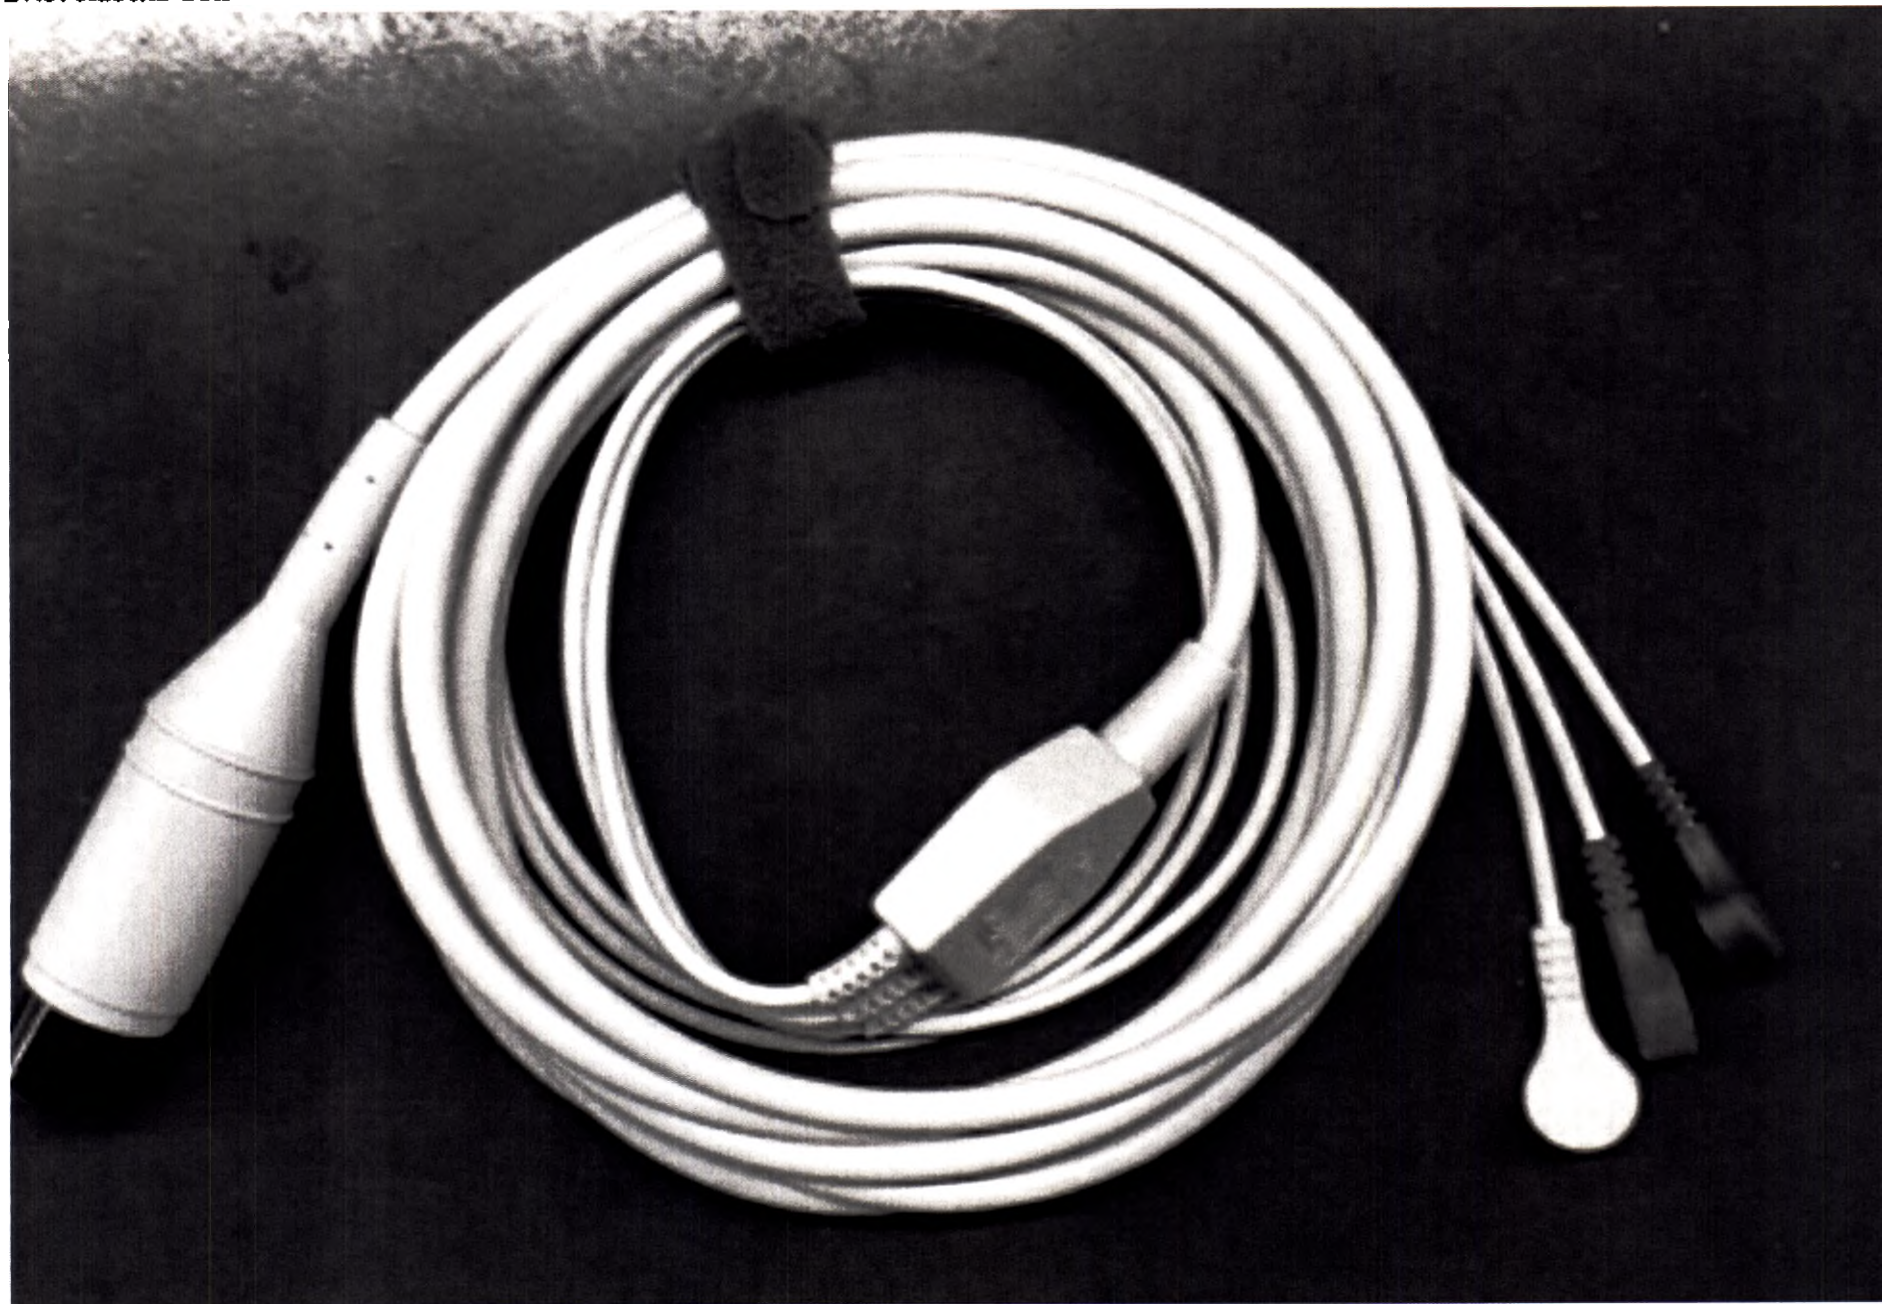

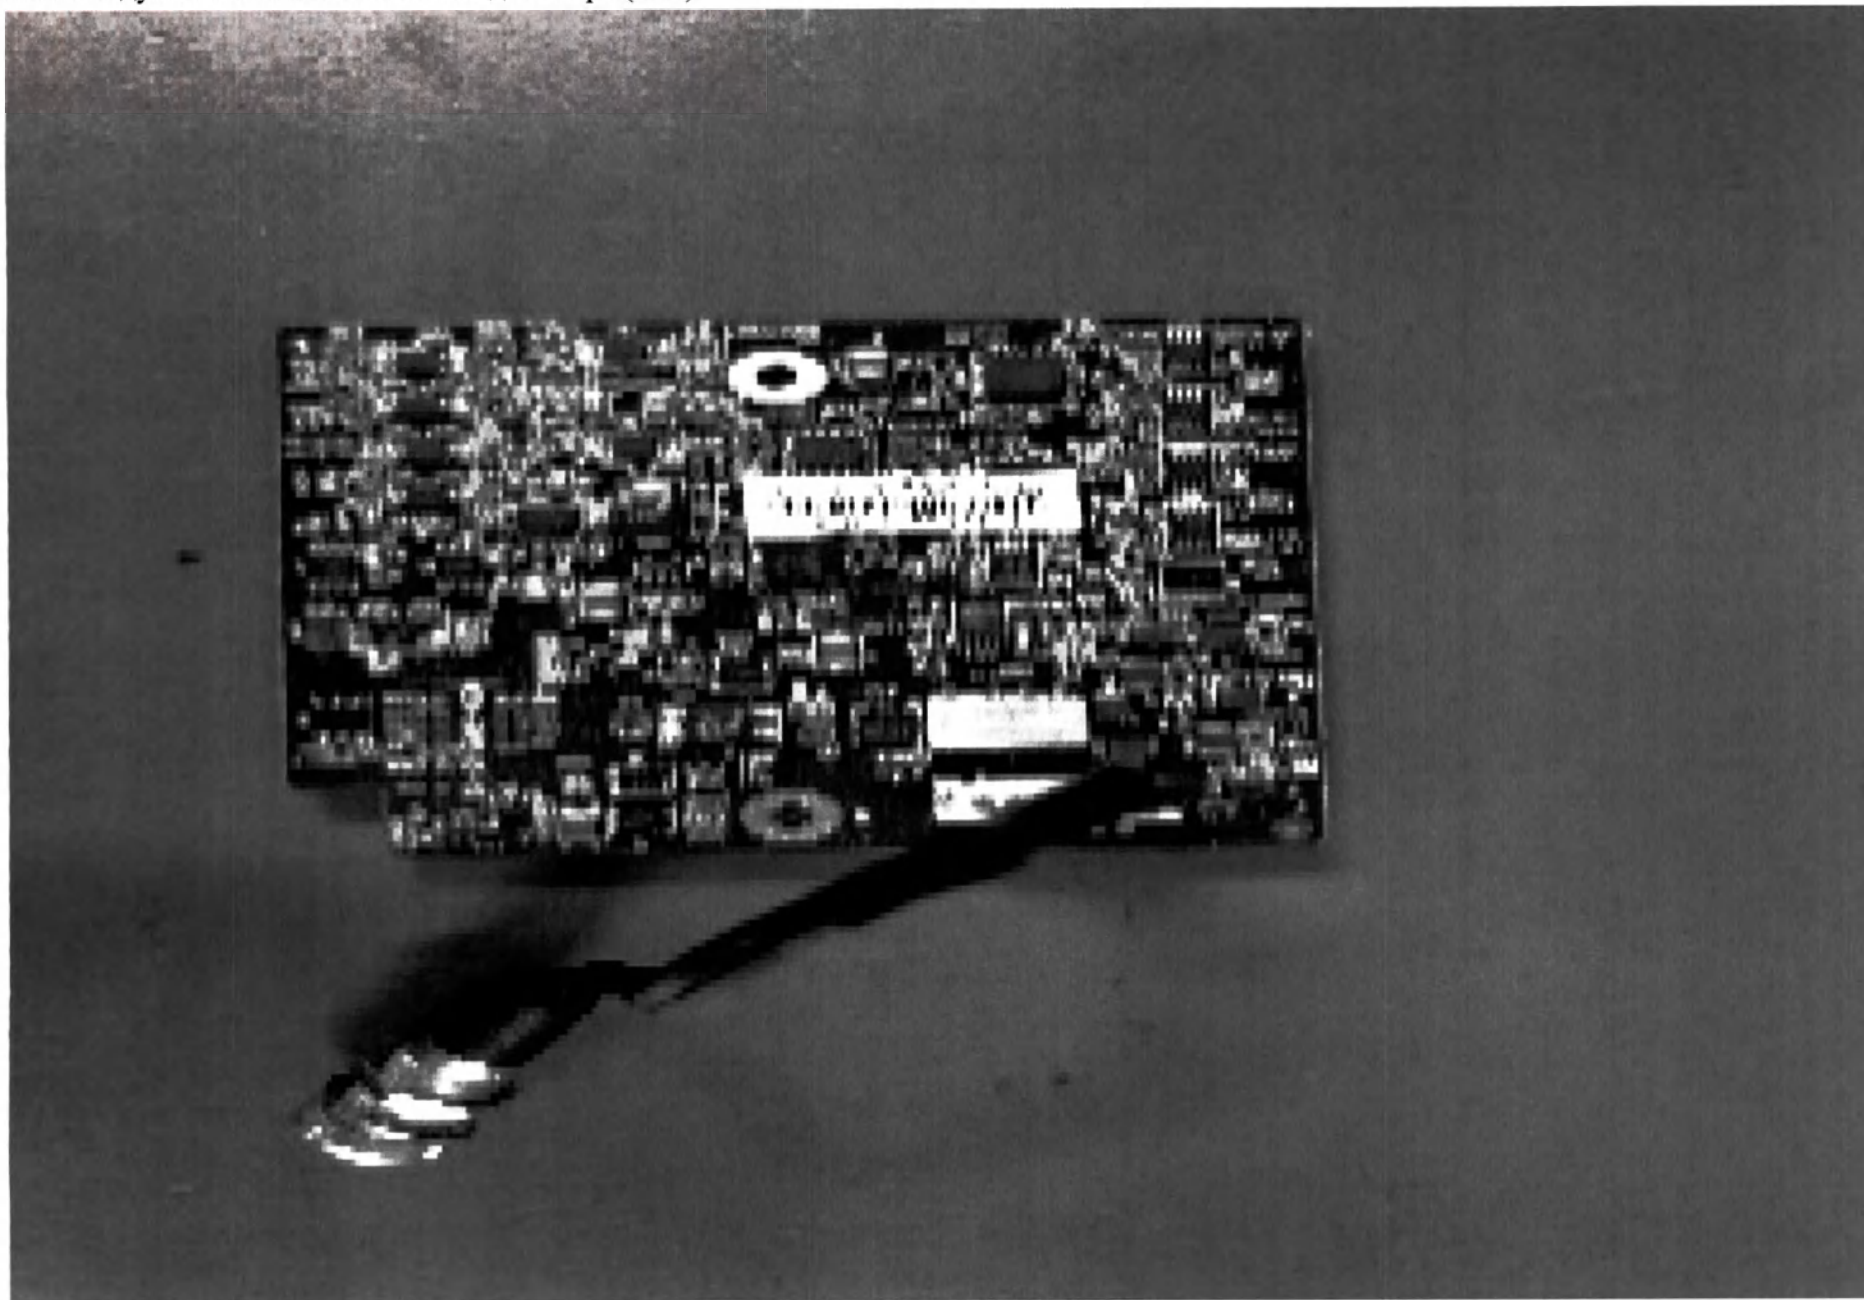



27.5. Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D/TEE Assembly)

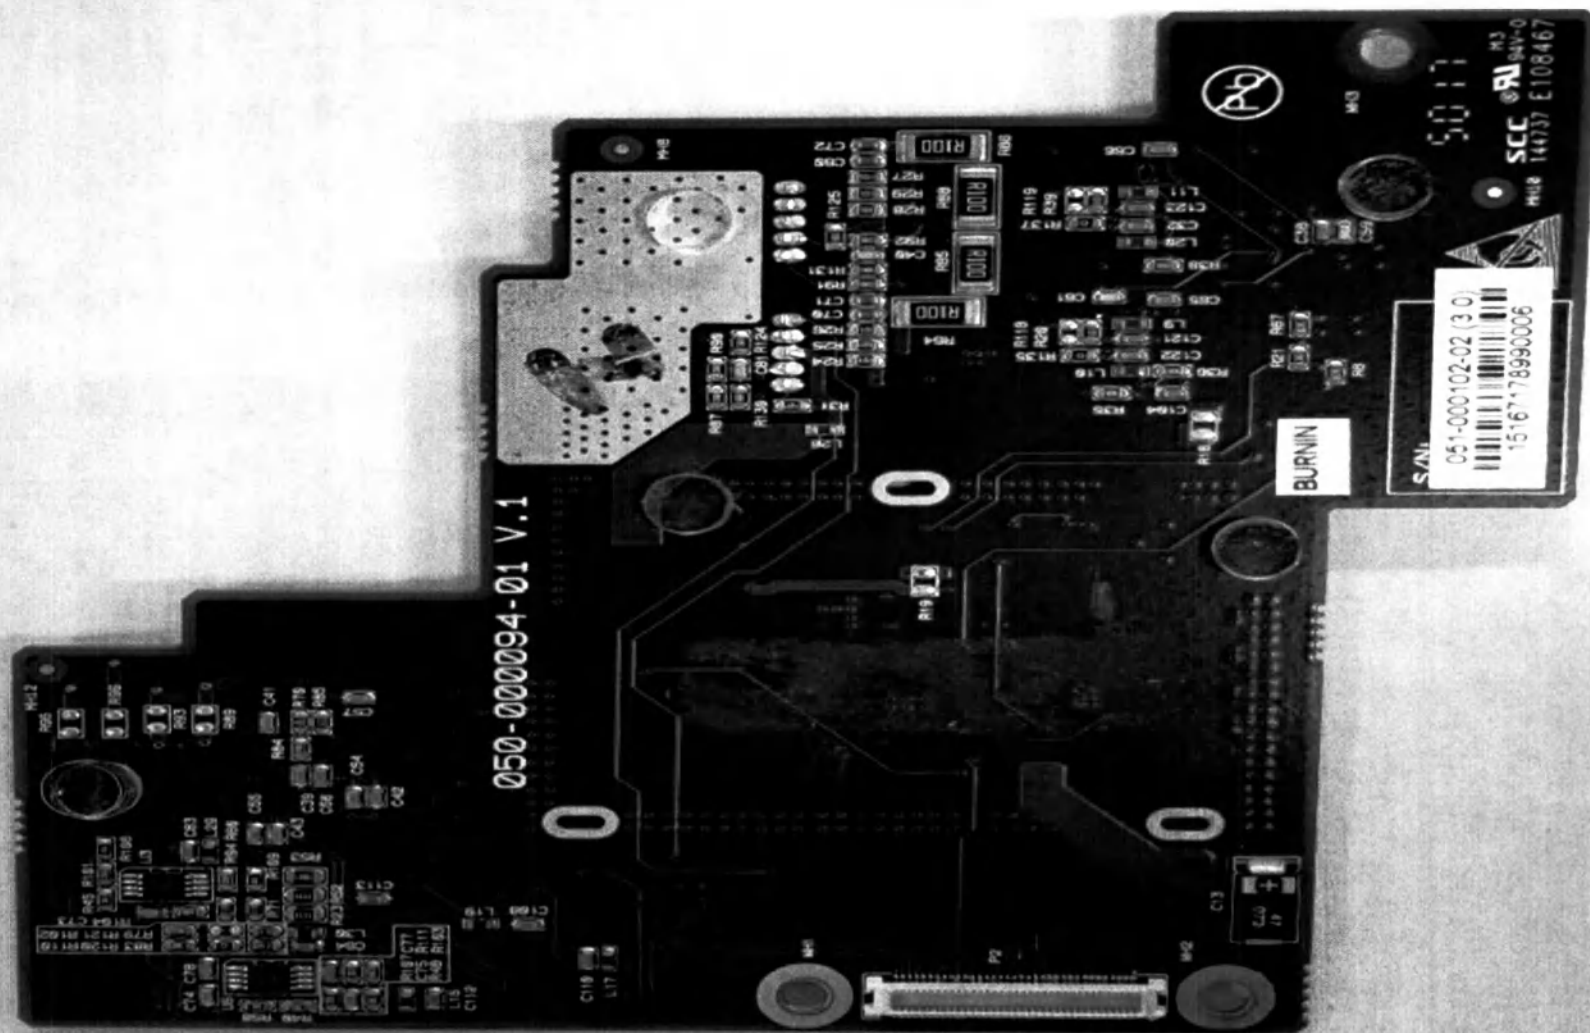


28. Тележки


28.1. Тележка мобильная UMT-300

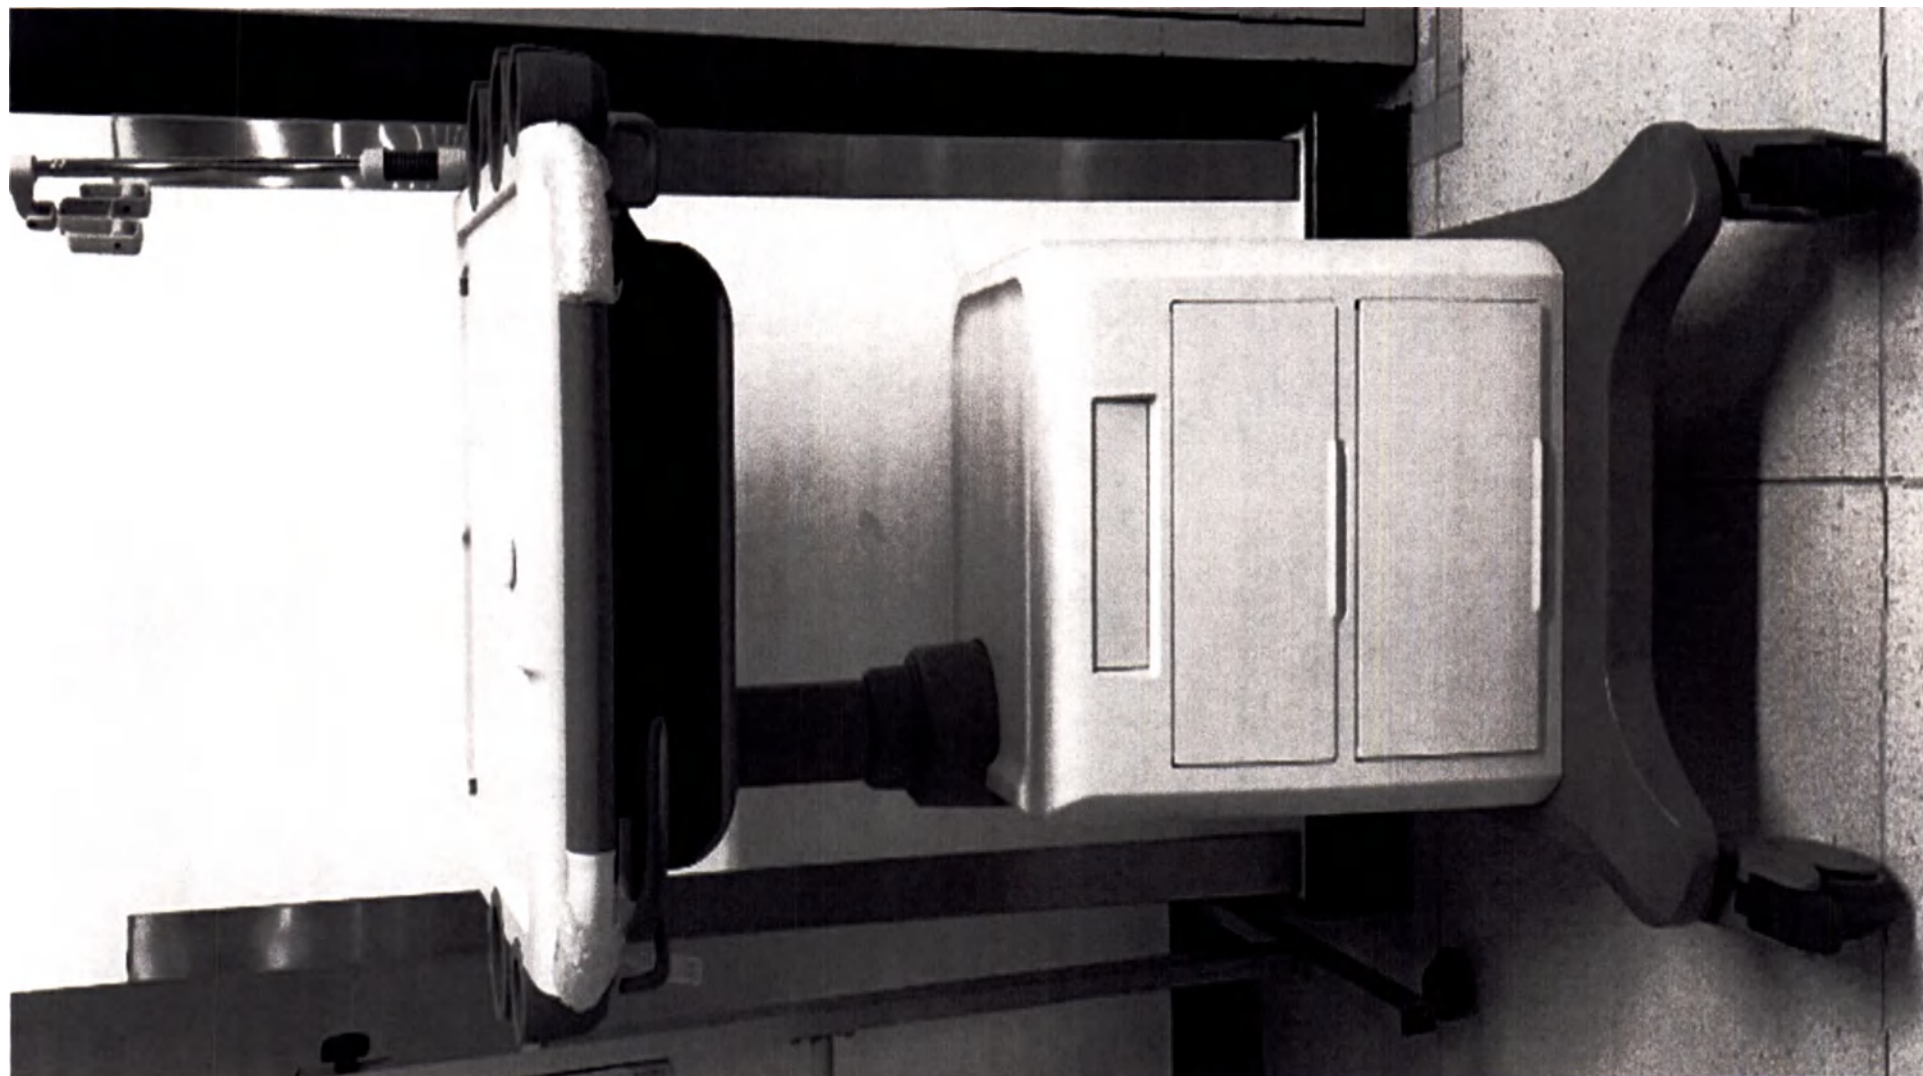

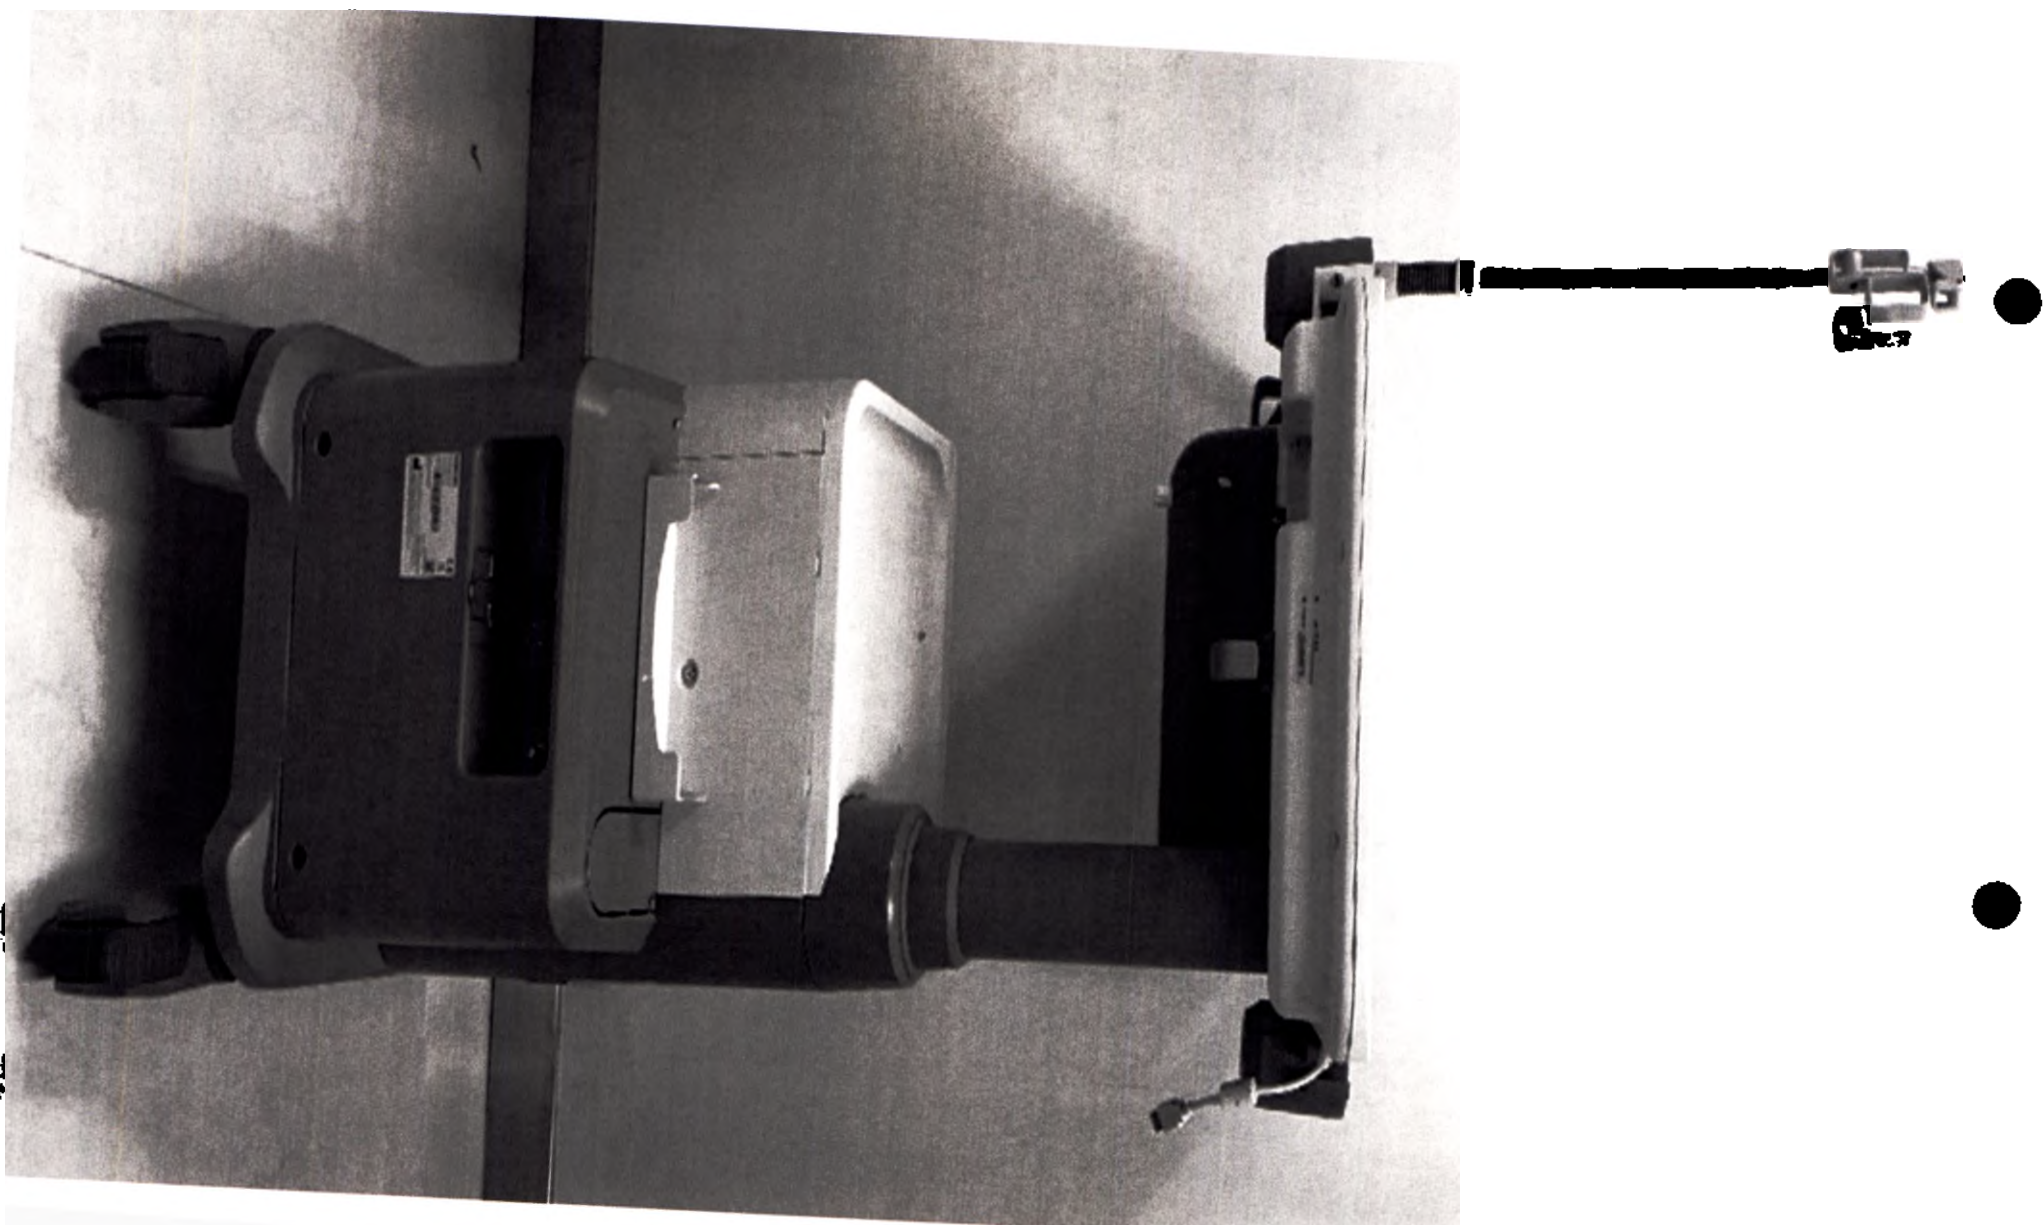


432

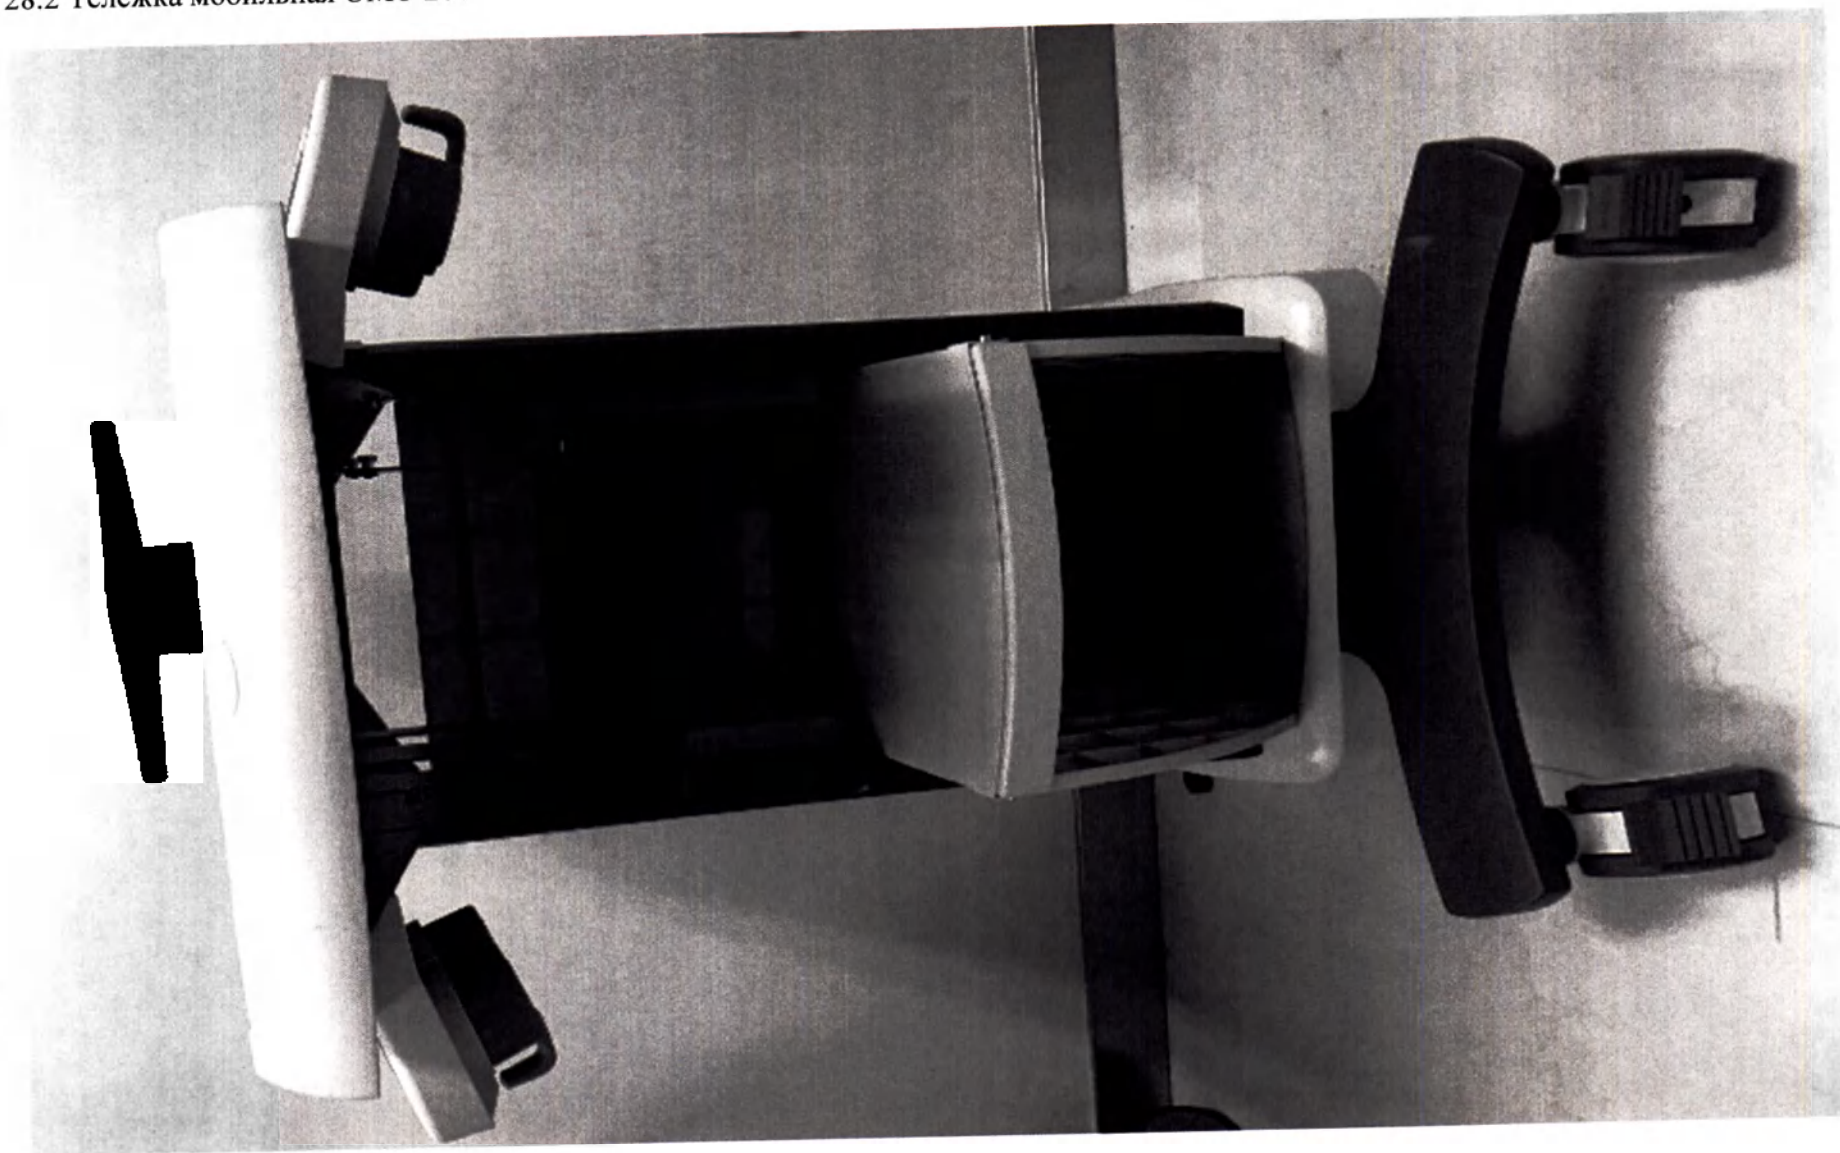

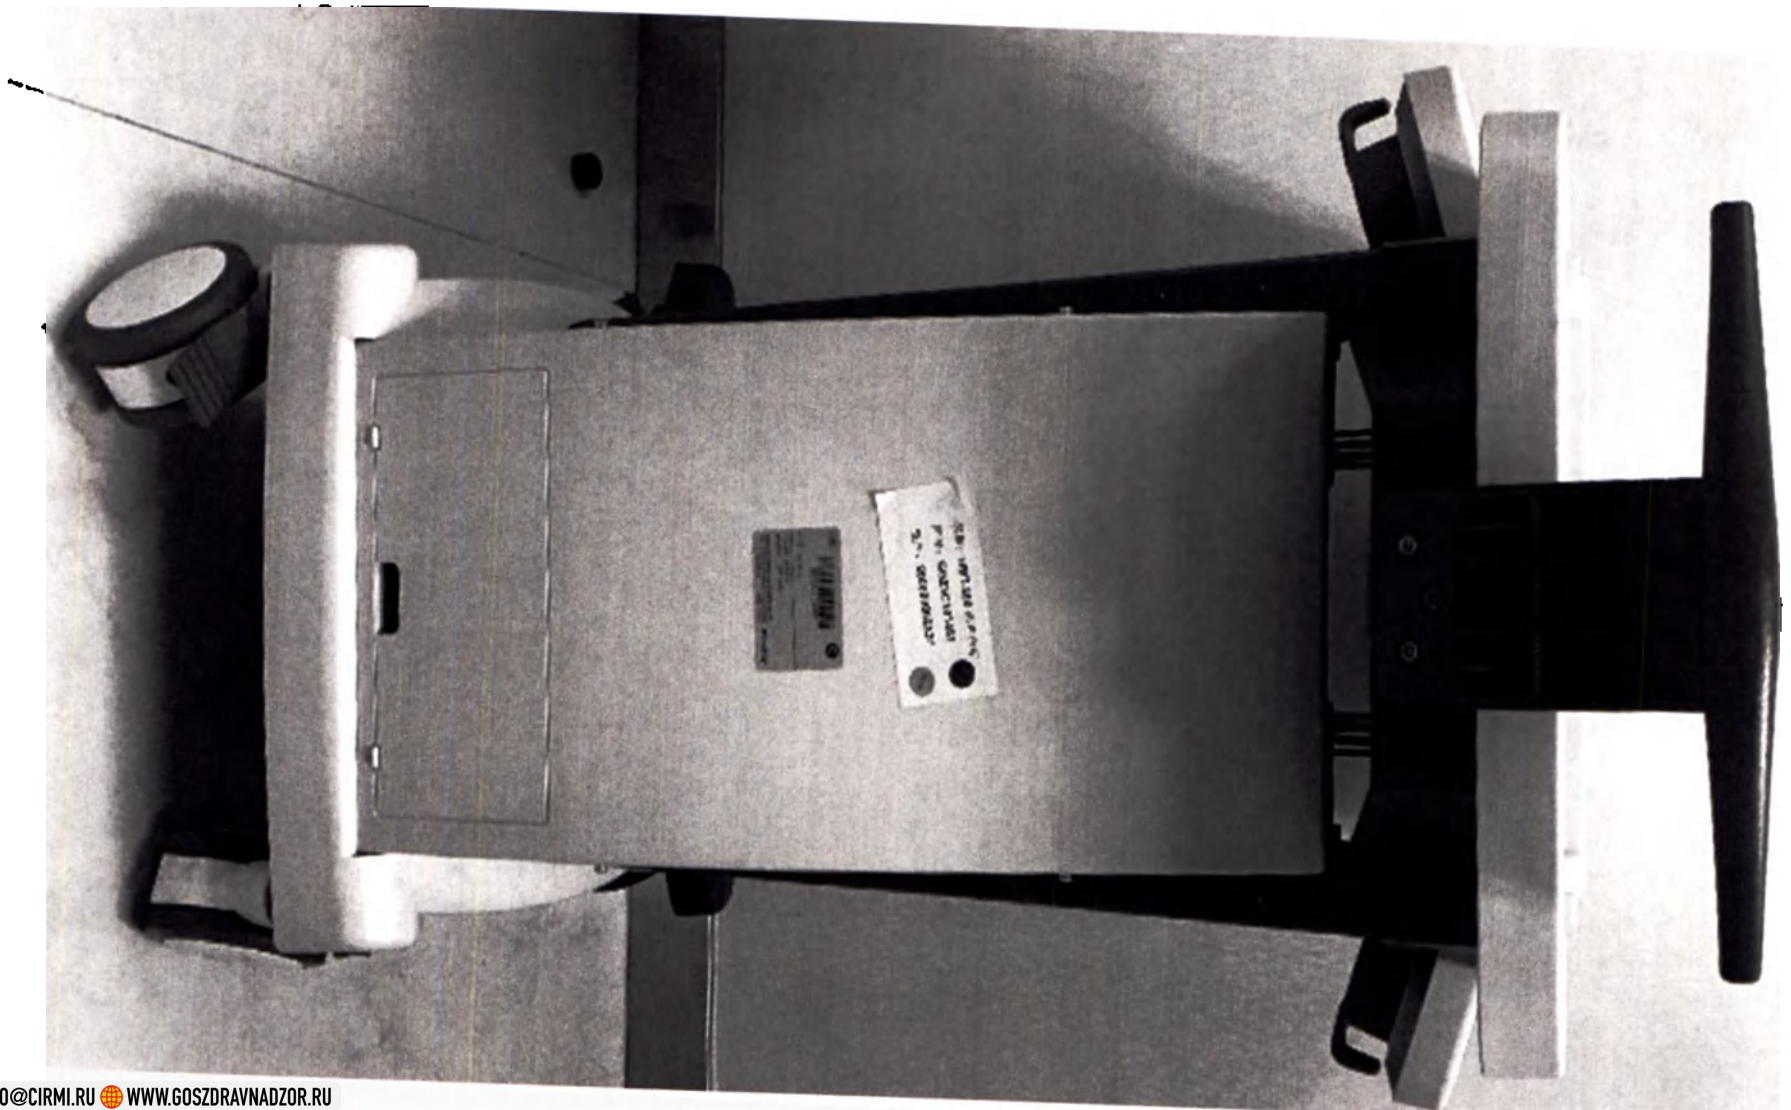


Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши

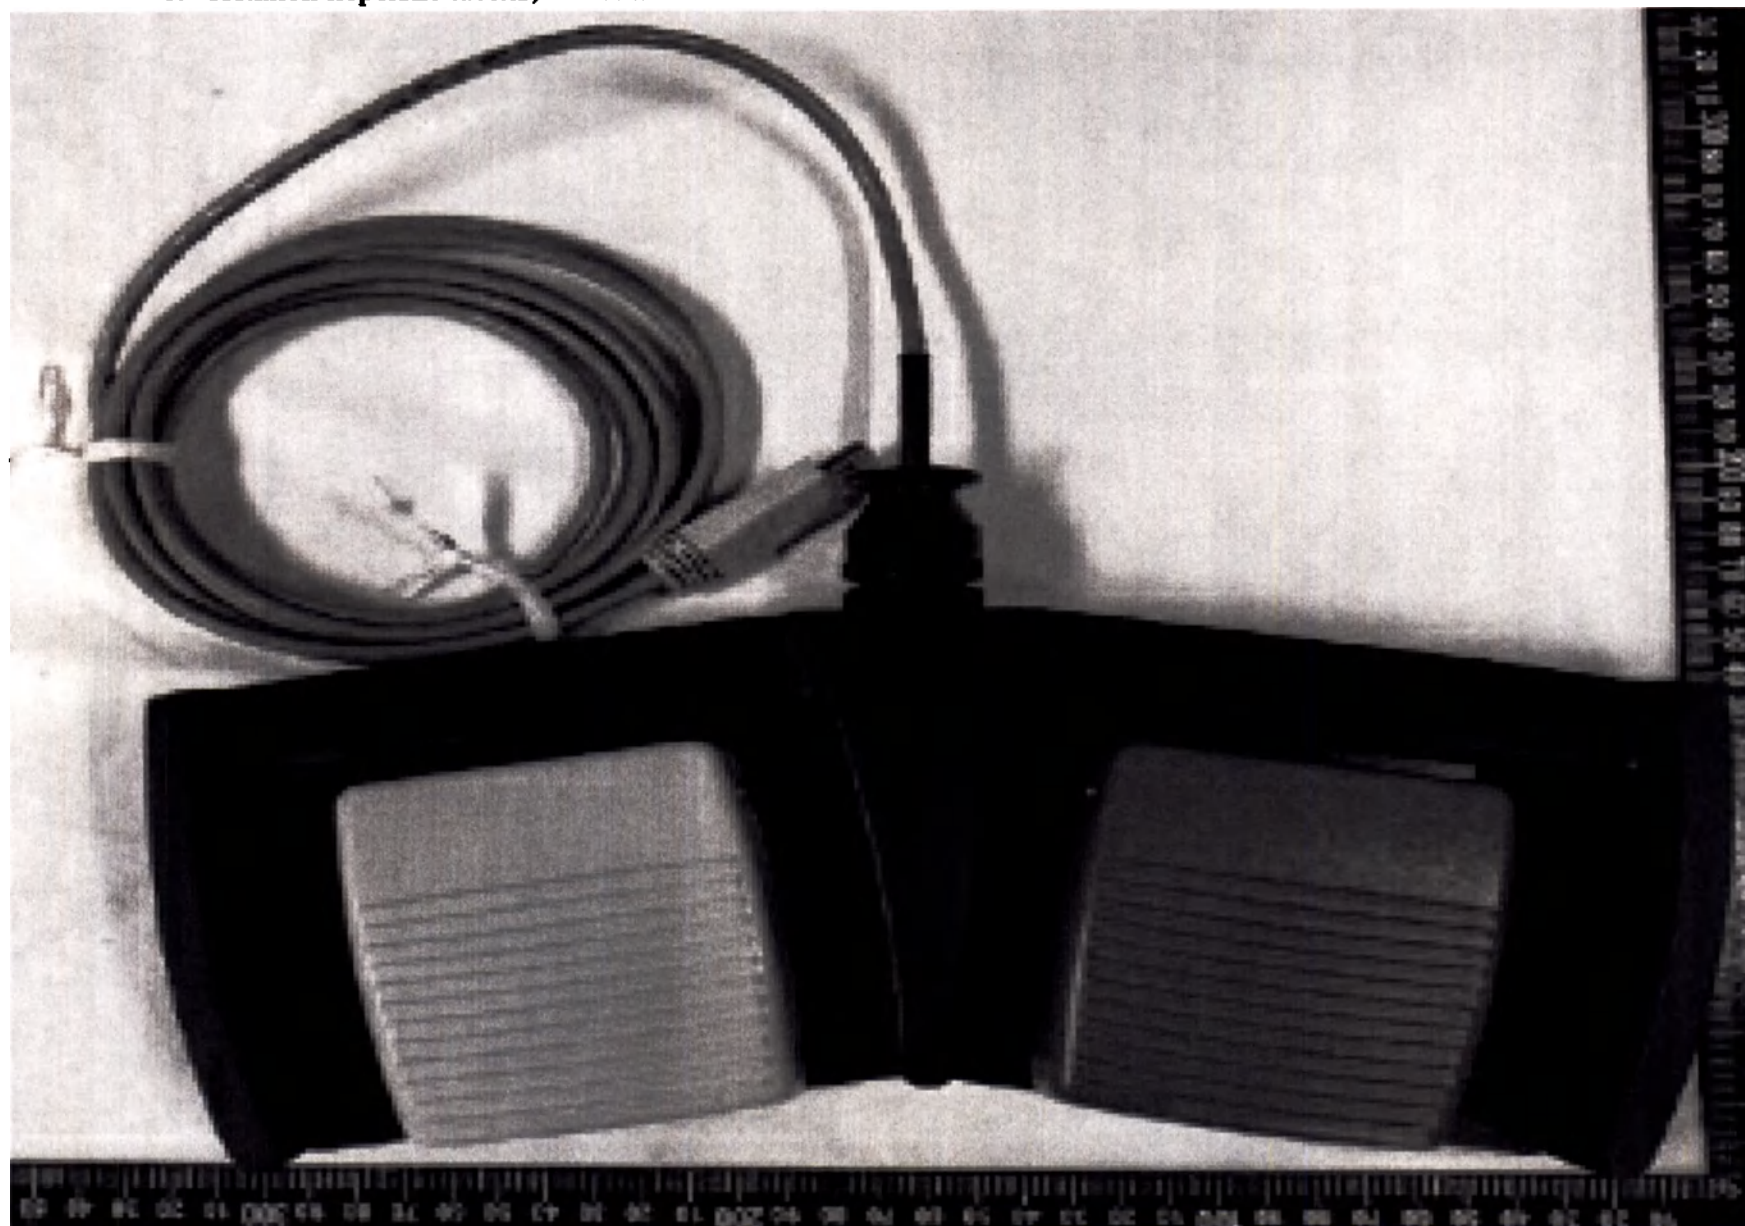


2.Ножной переключатель, 3 клавиши

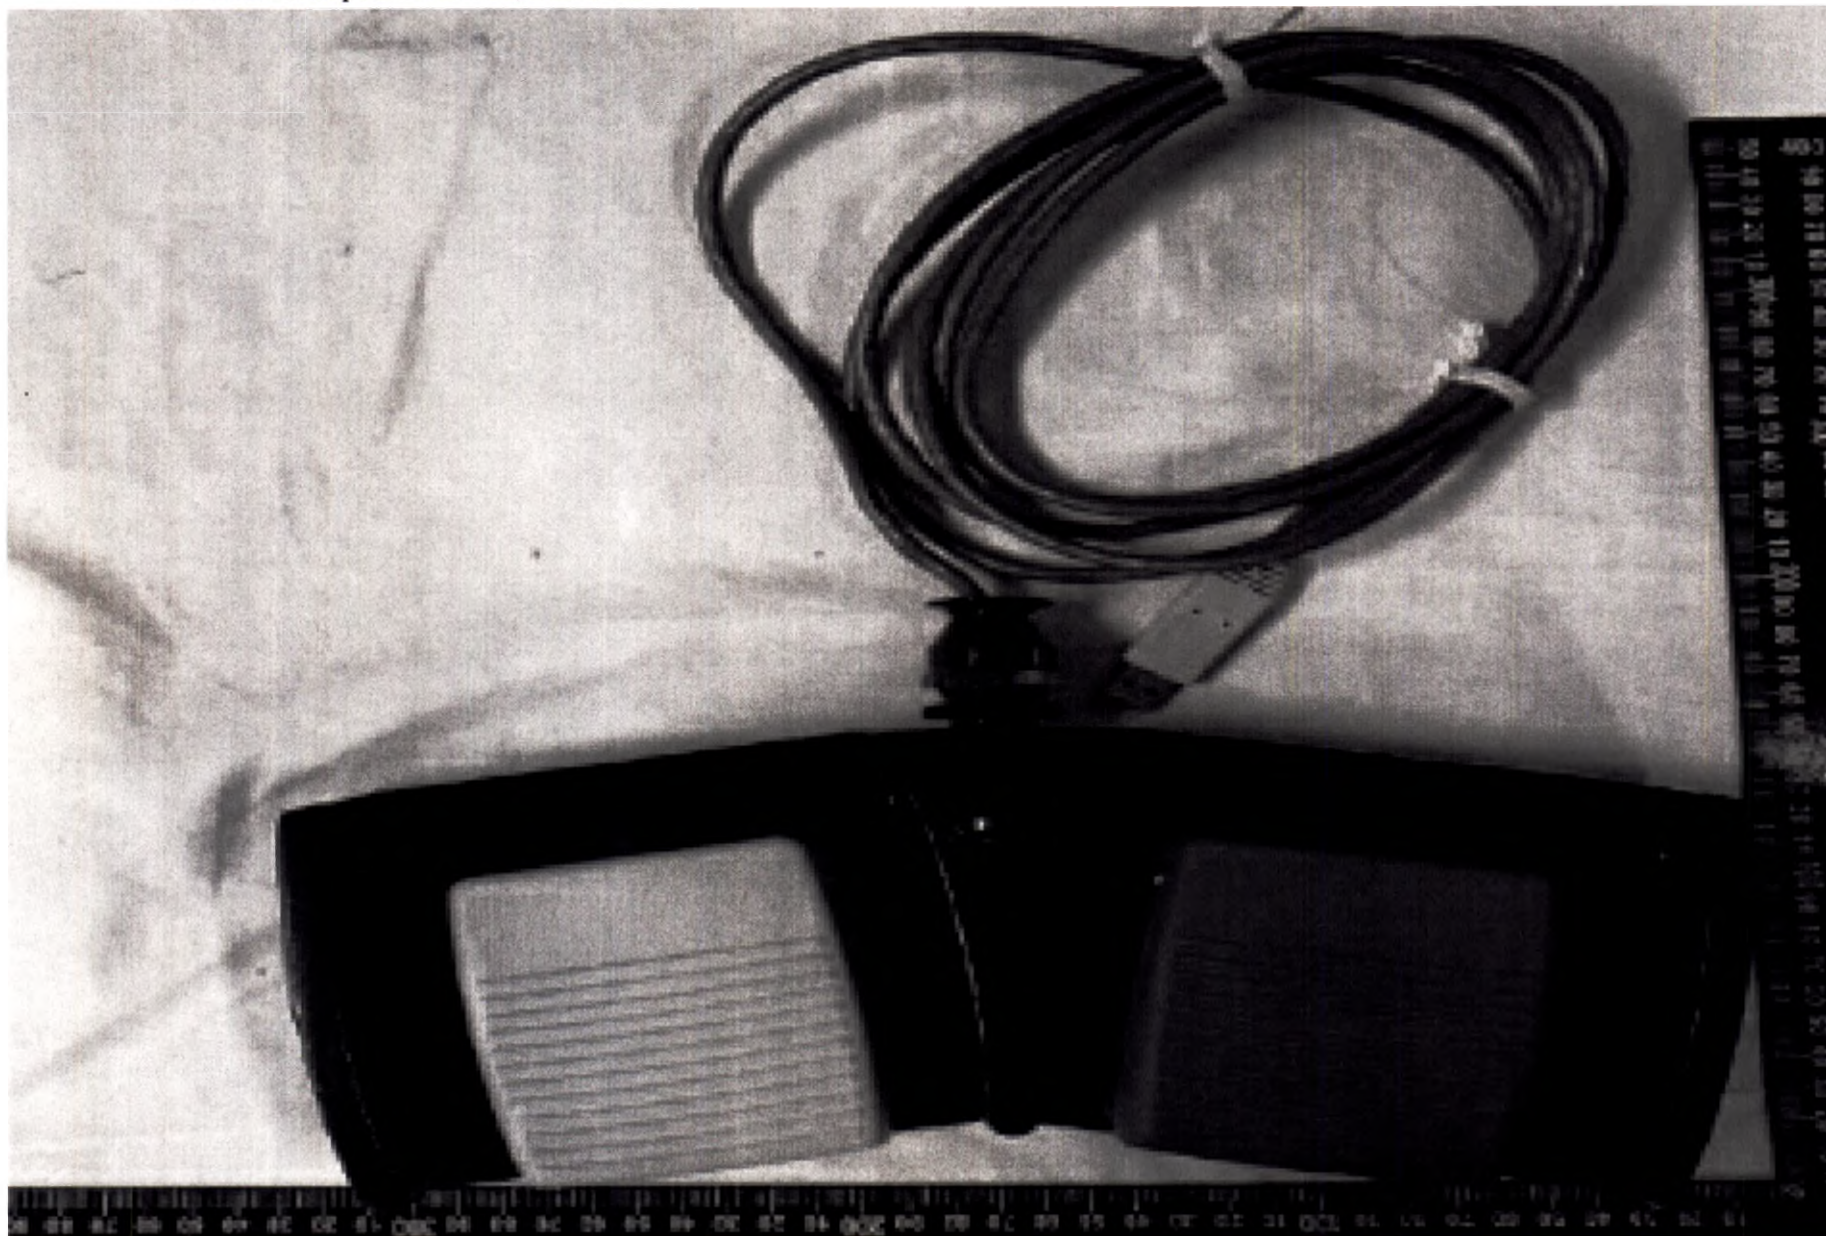


V. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М6 Pro, в составе:


1. Основной блок М6 Pro



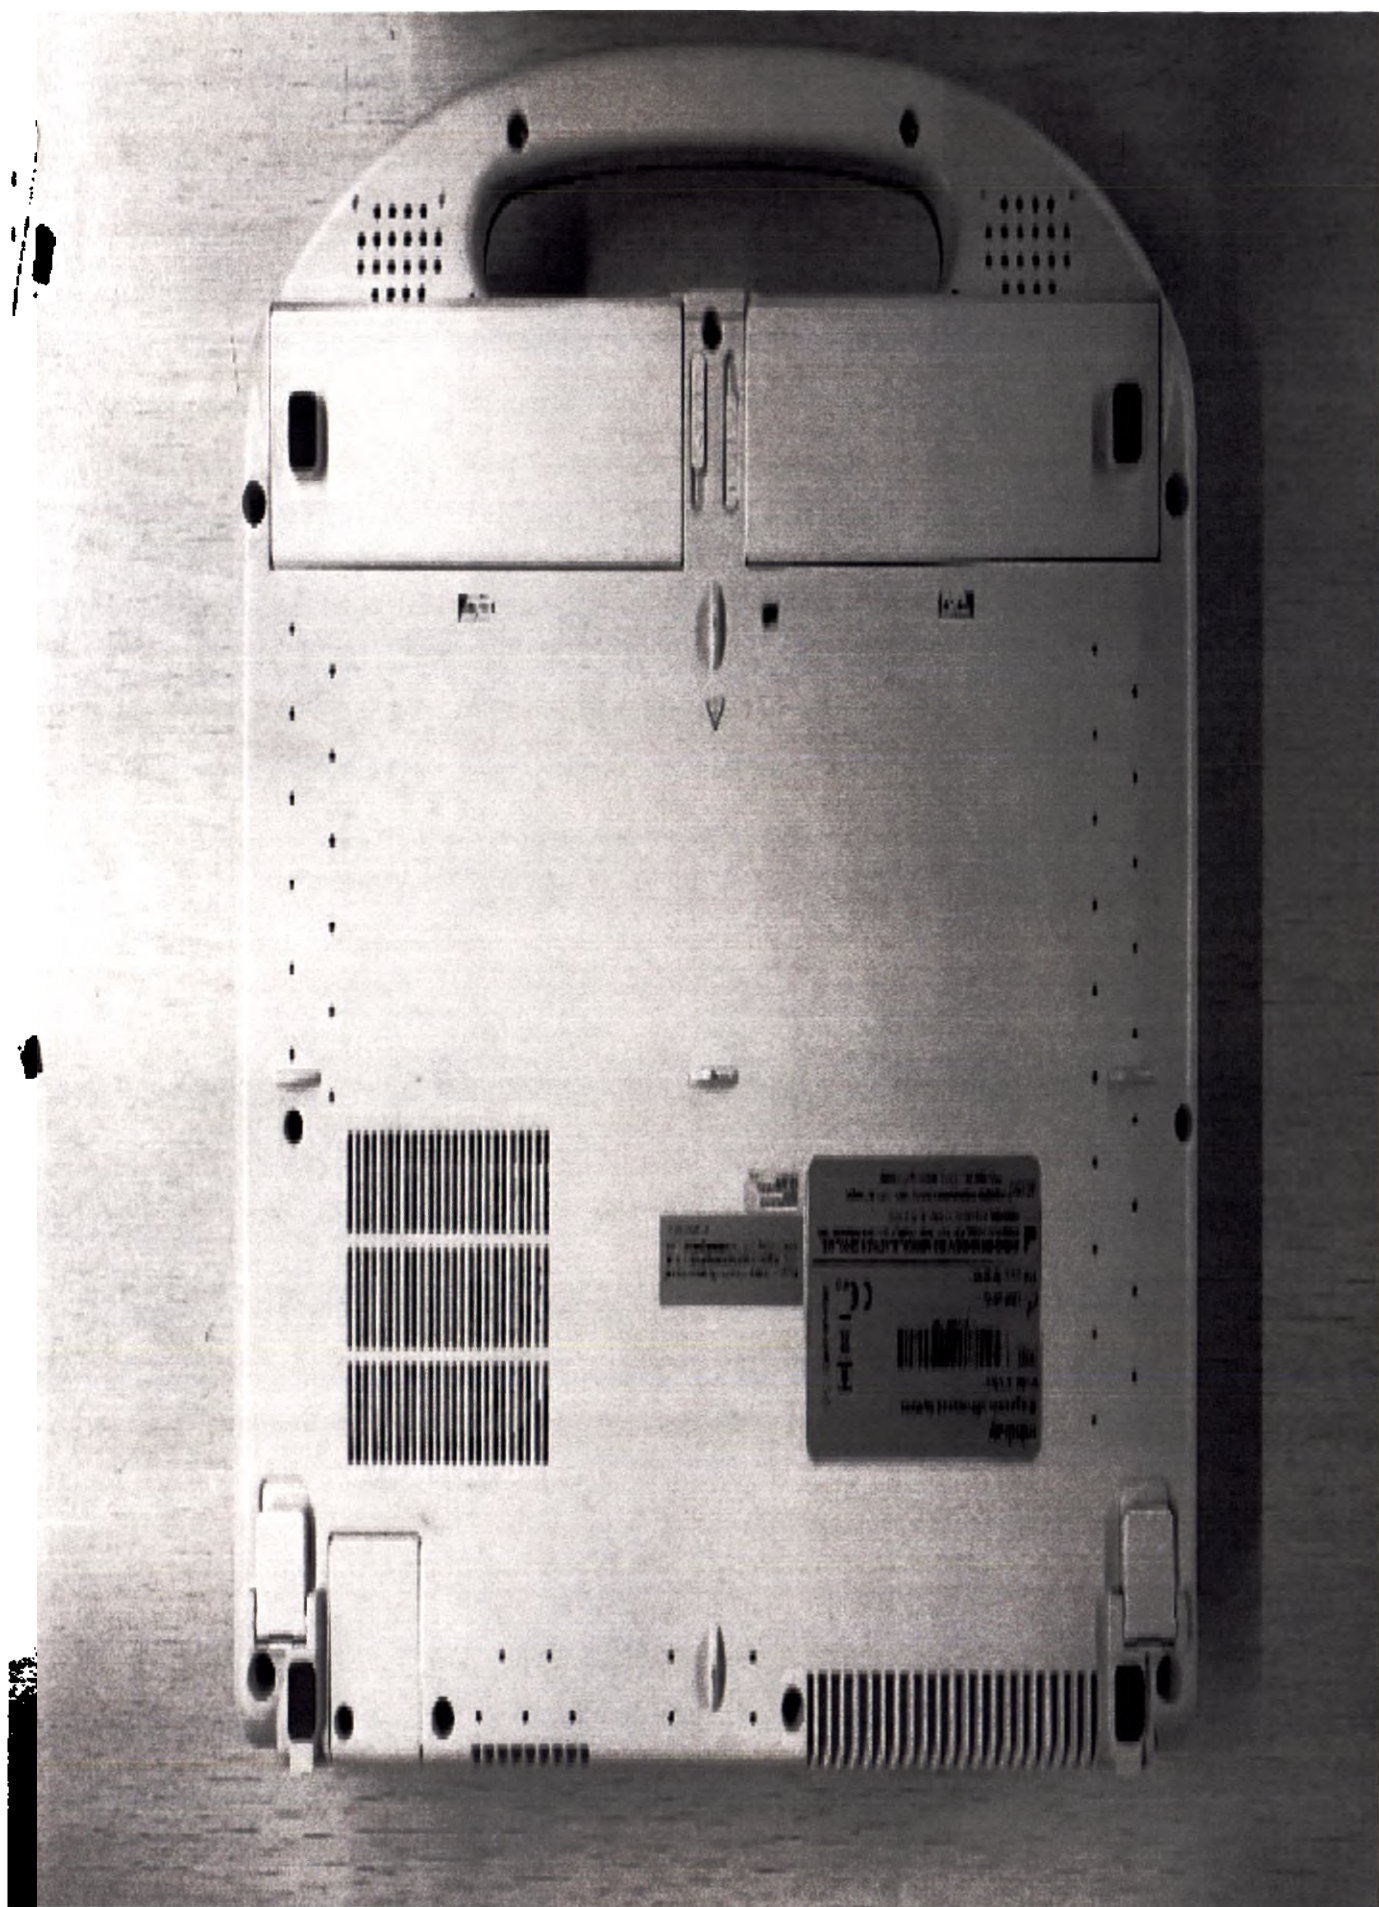


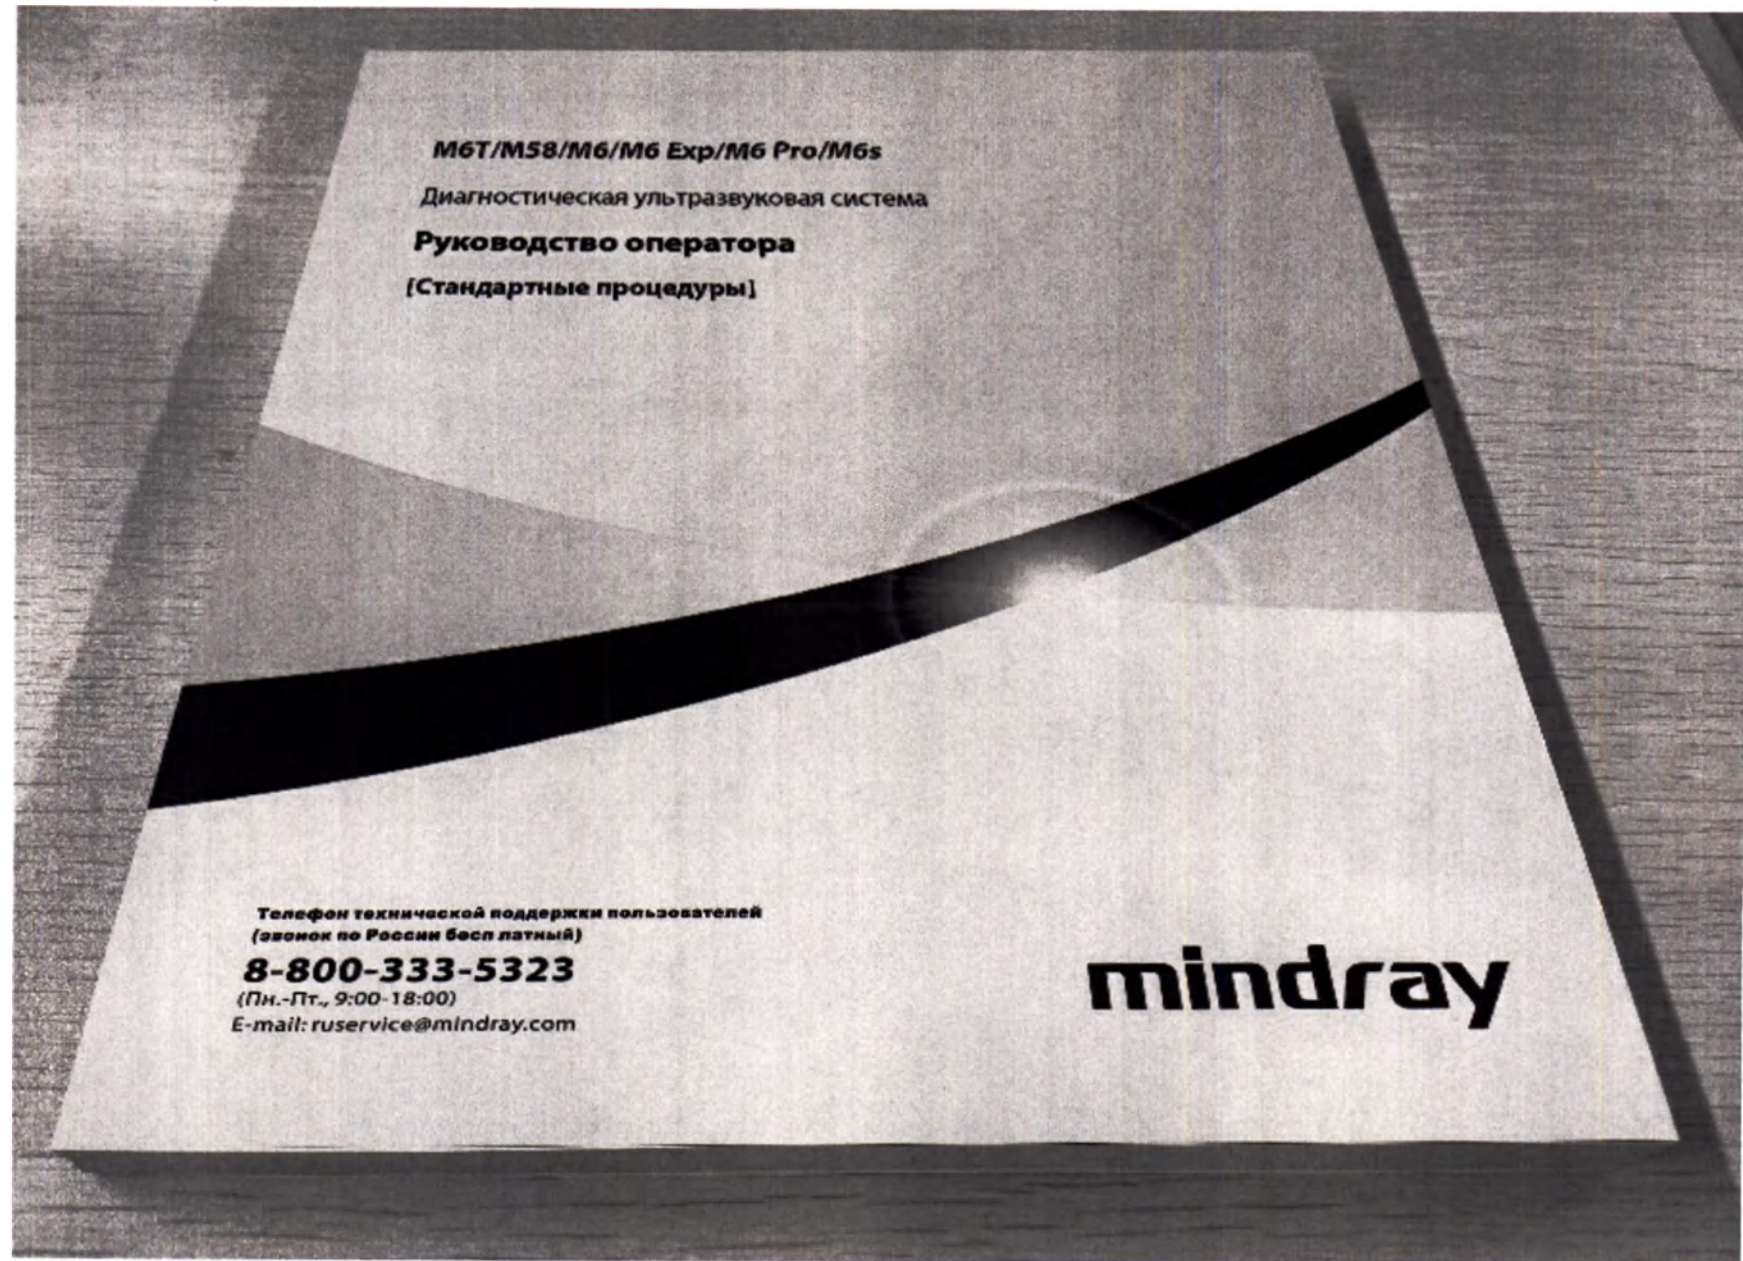

4. Кабель питания

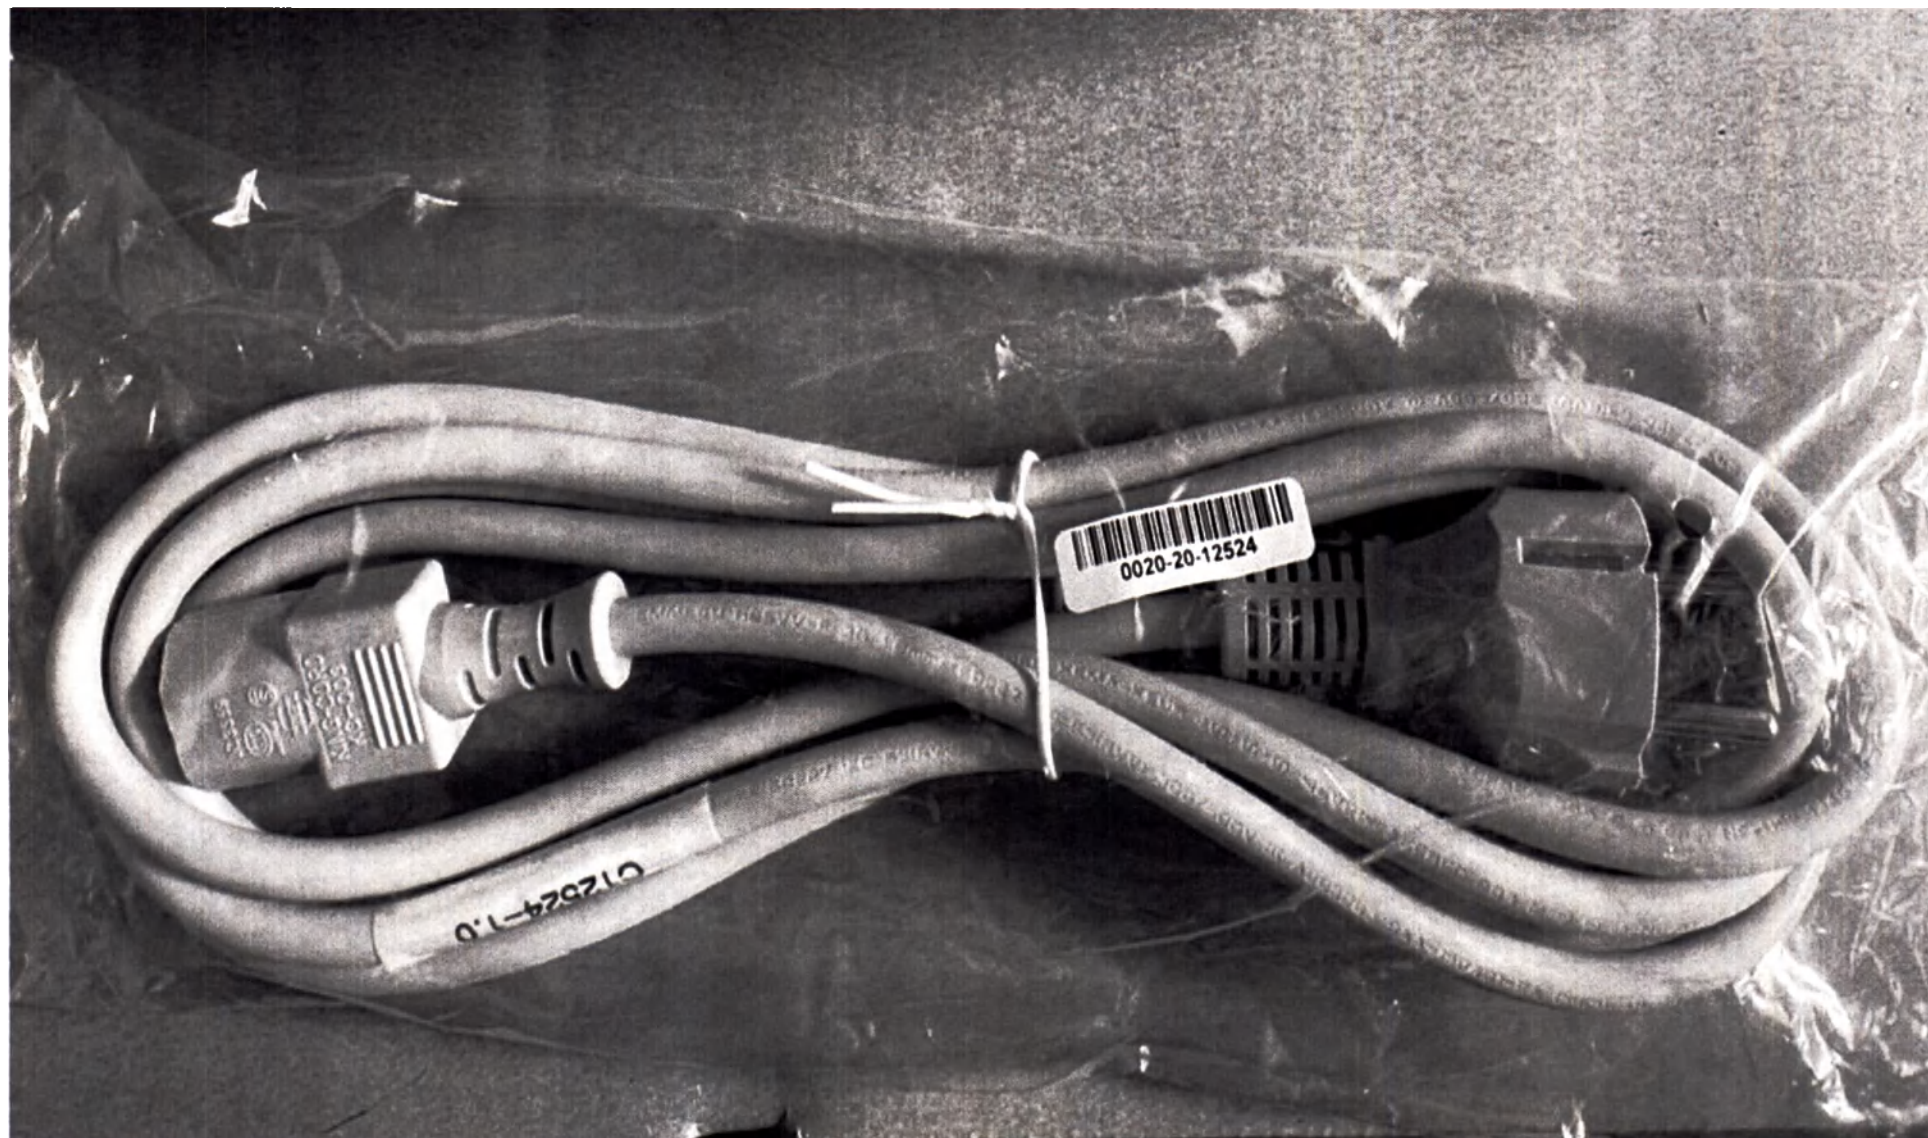

5. Накладка на панель управления(русифицированная)

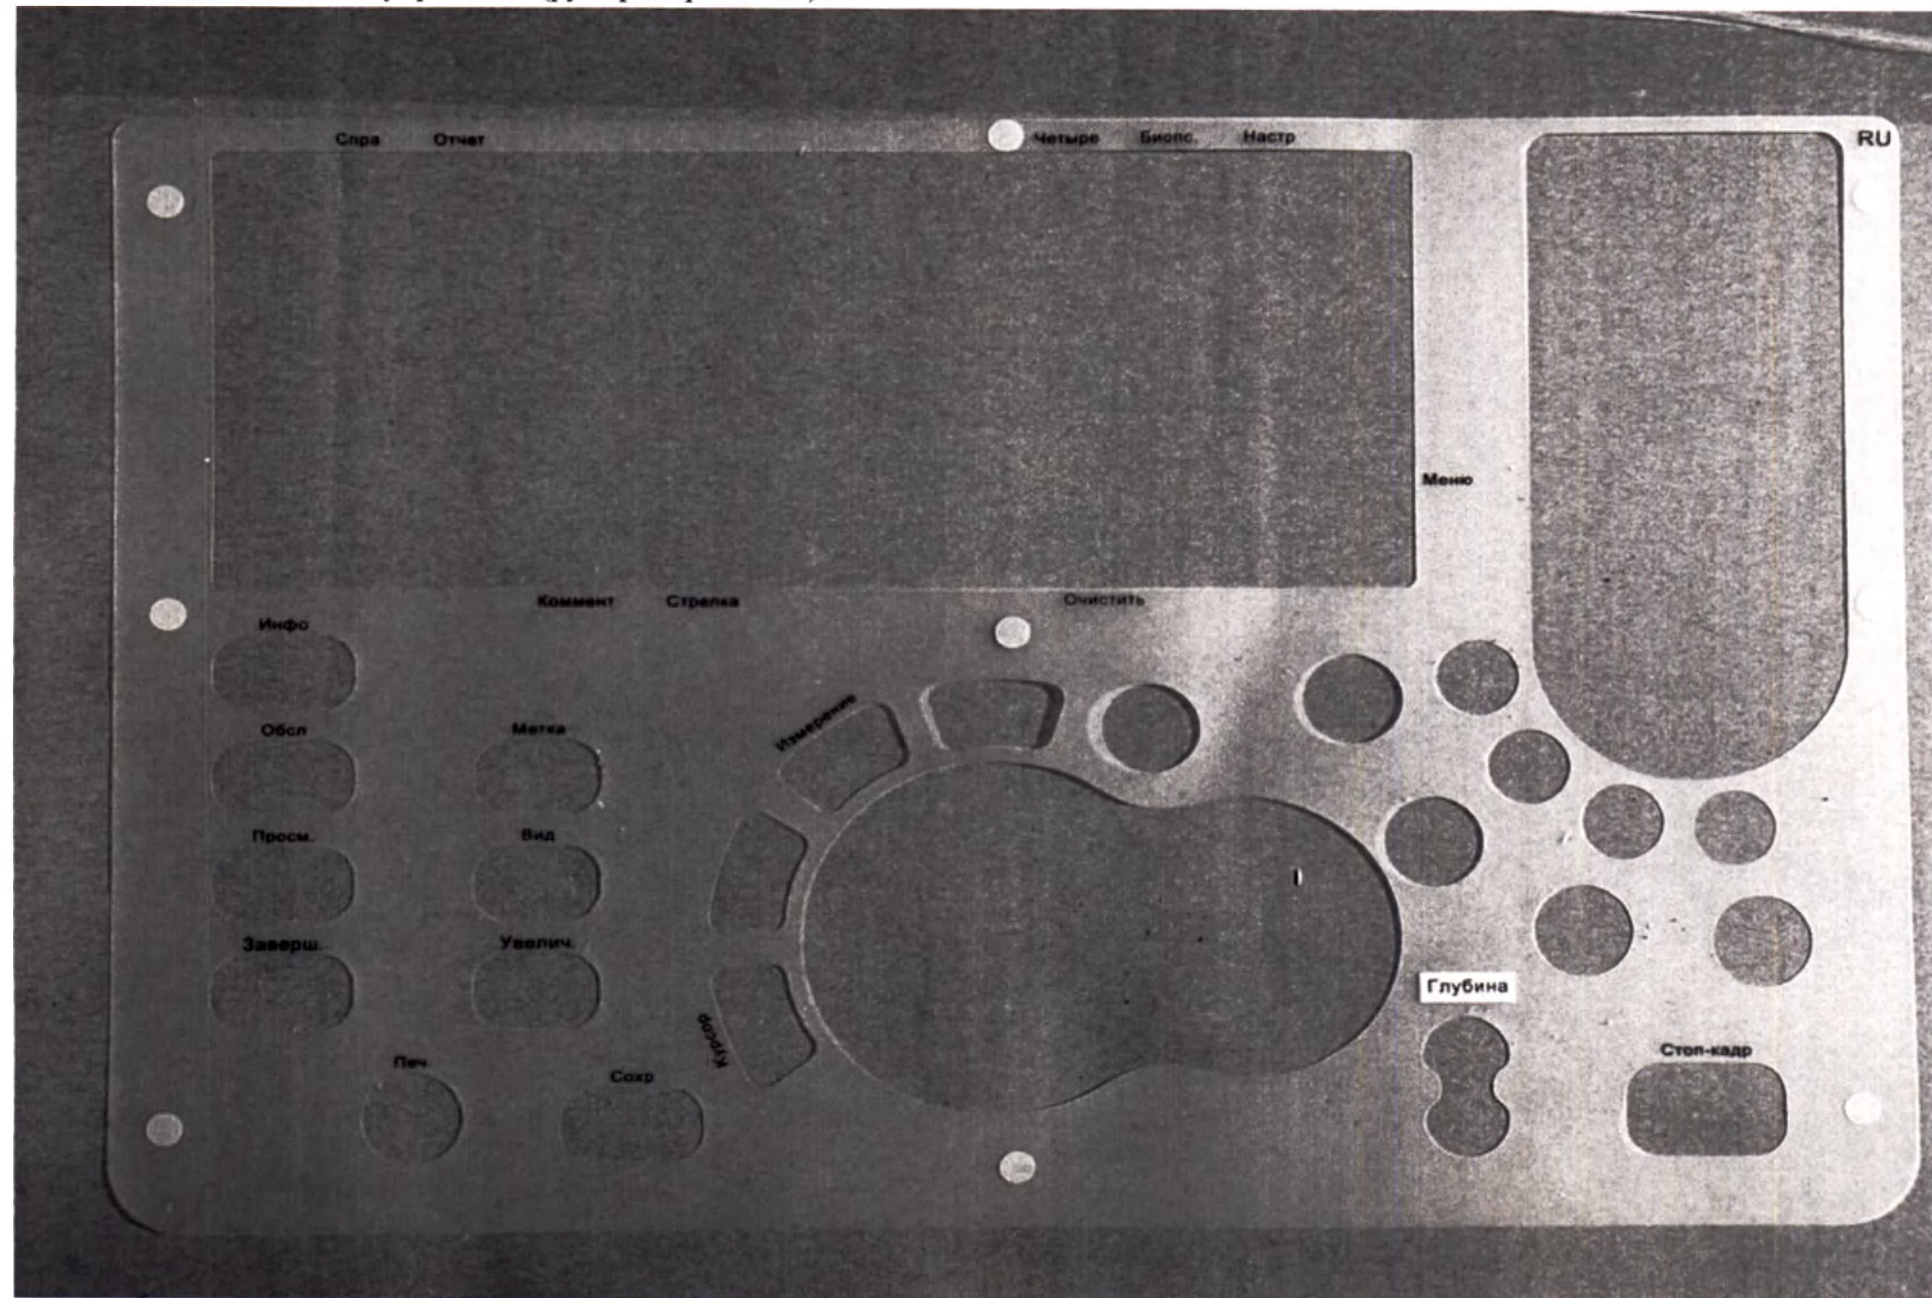


6. Адаптер питания







8. Разветвитель для датчиков

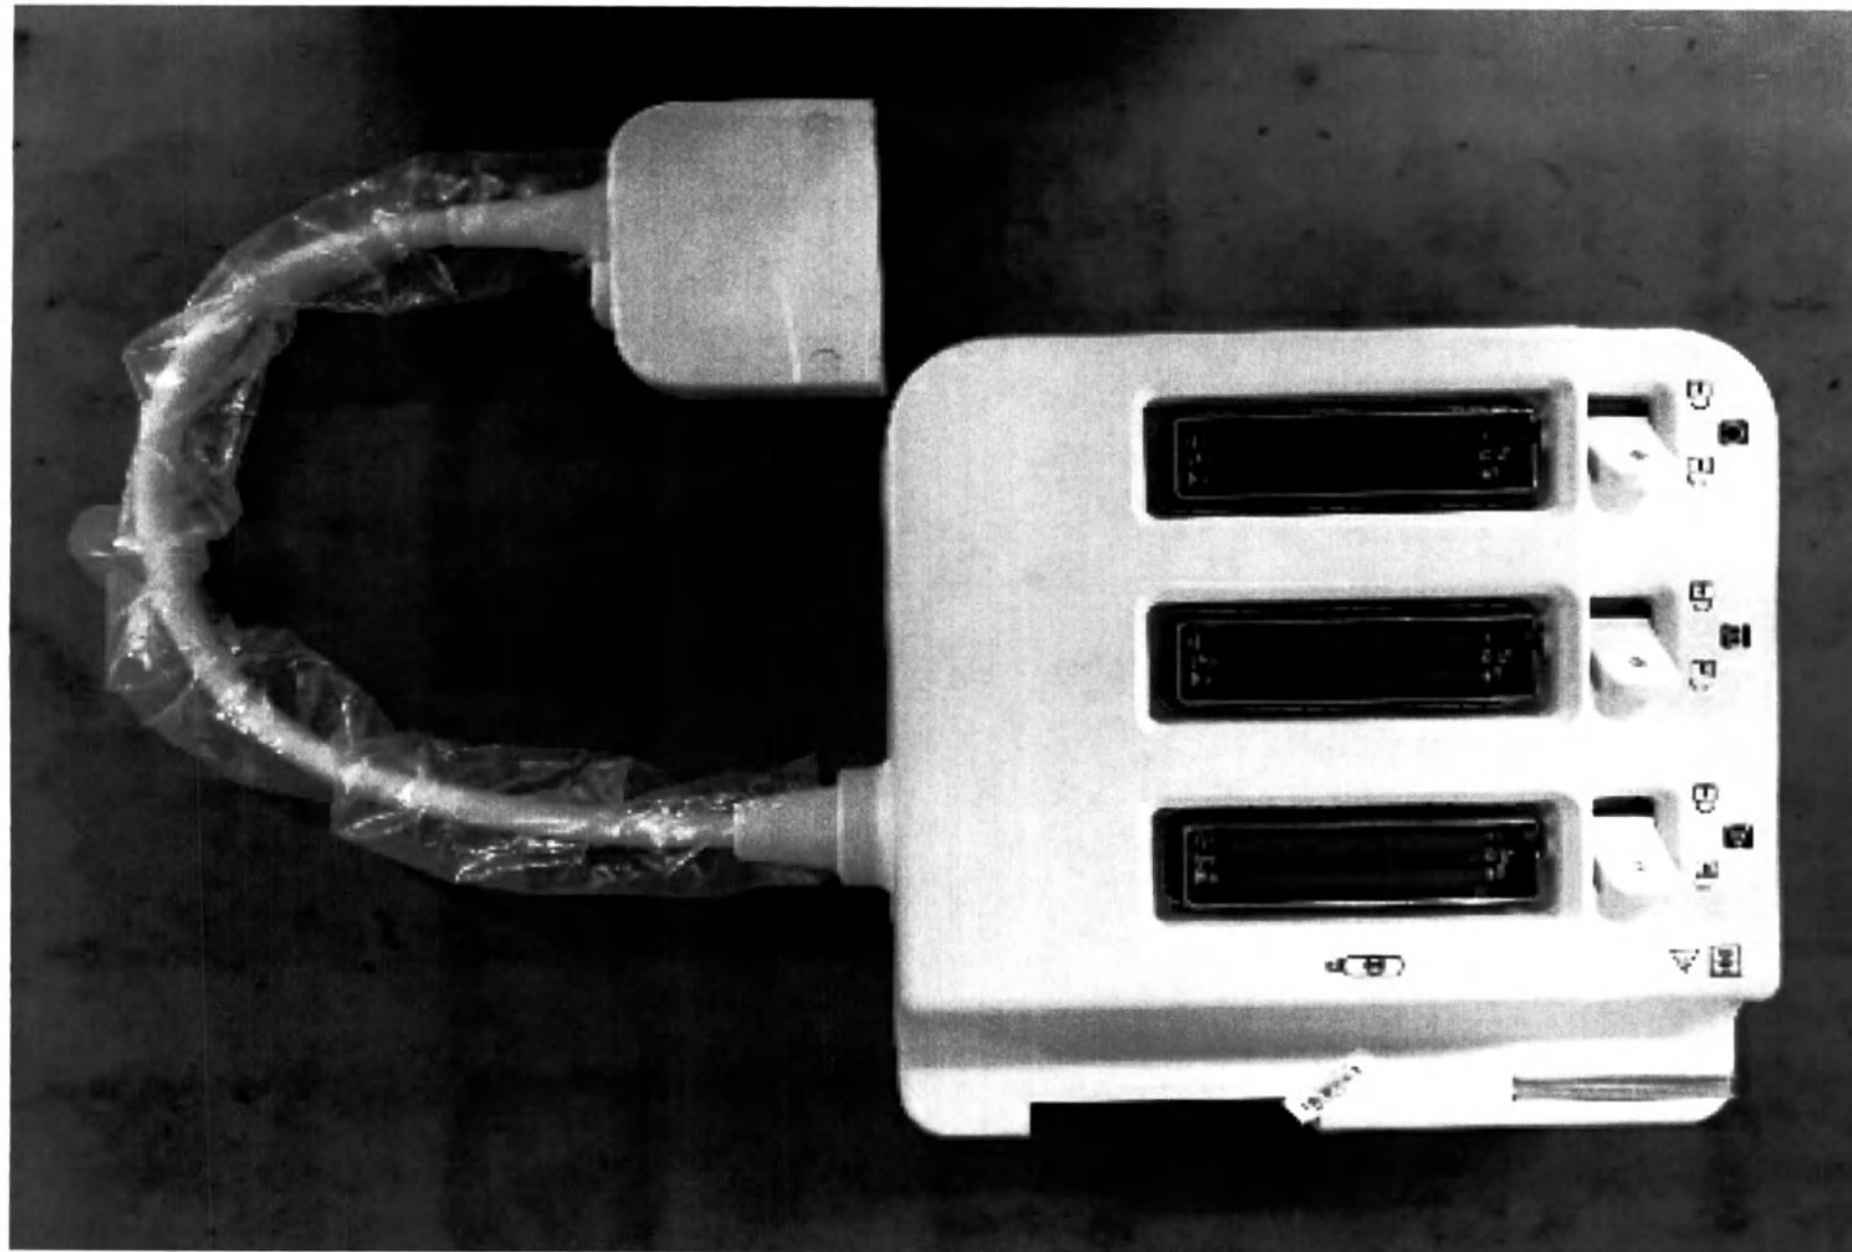


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

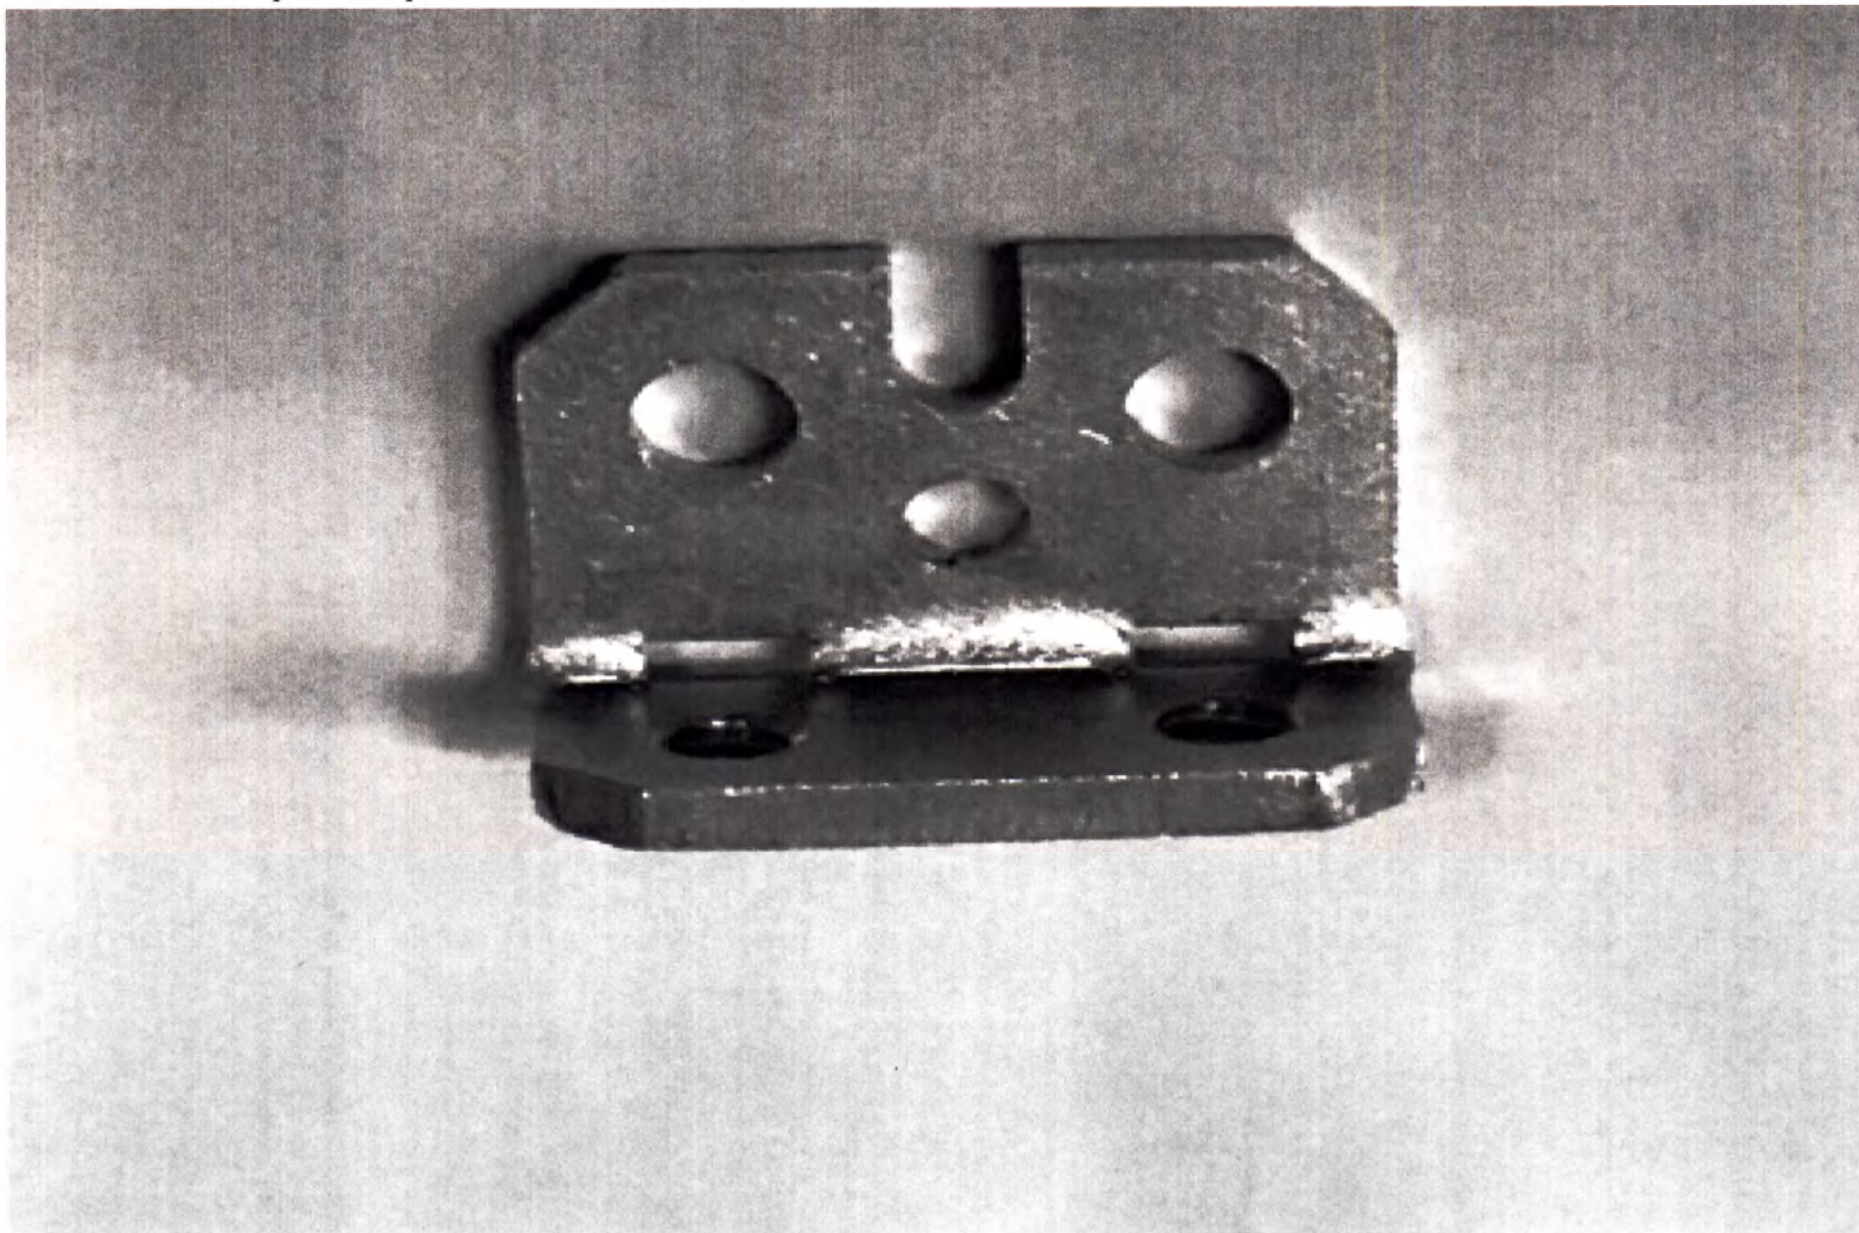

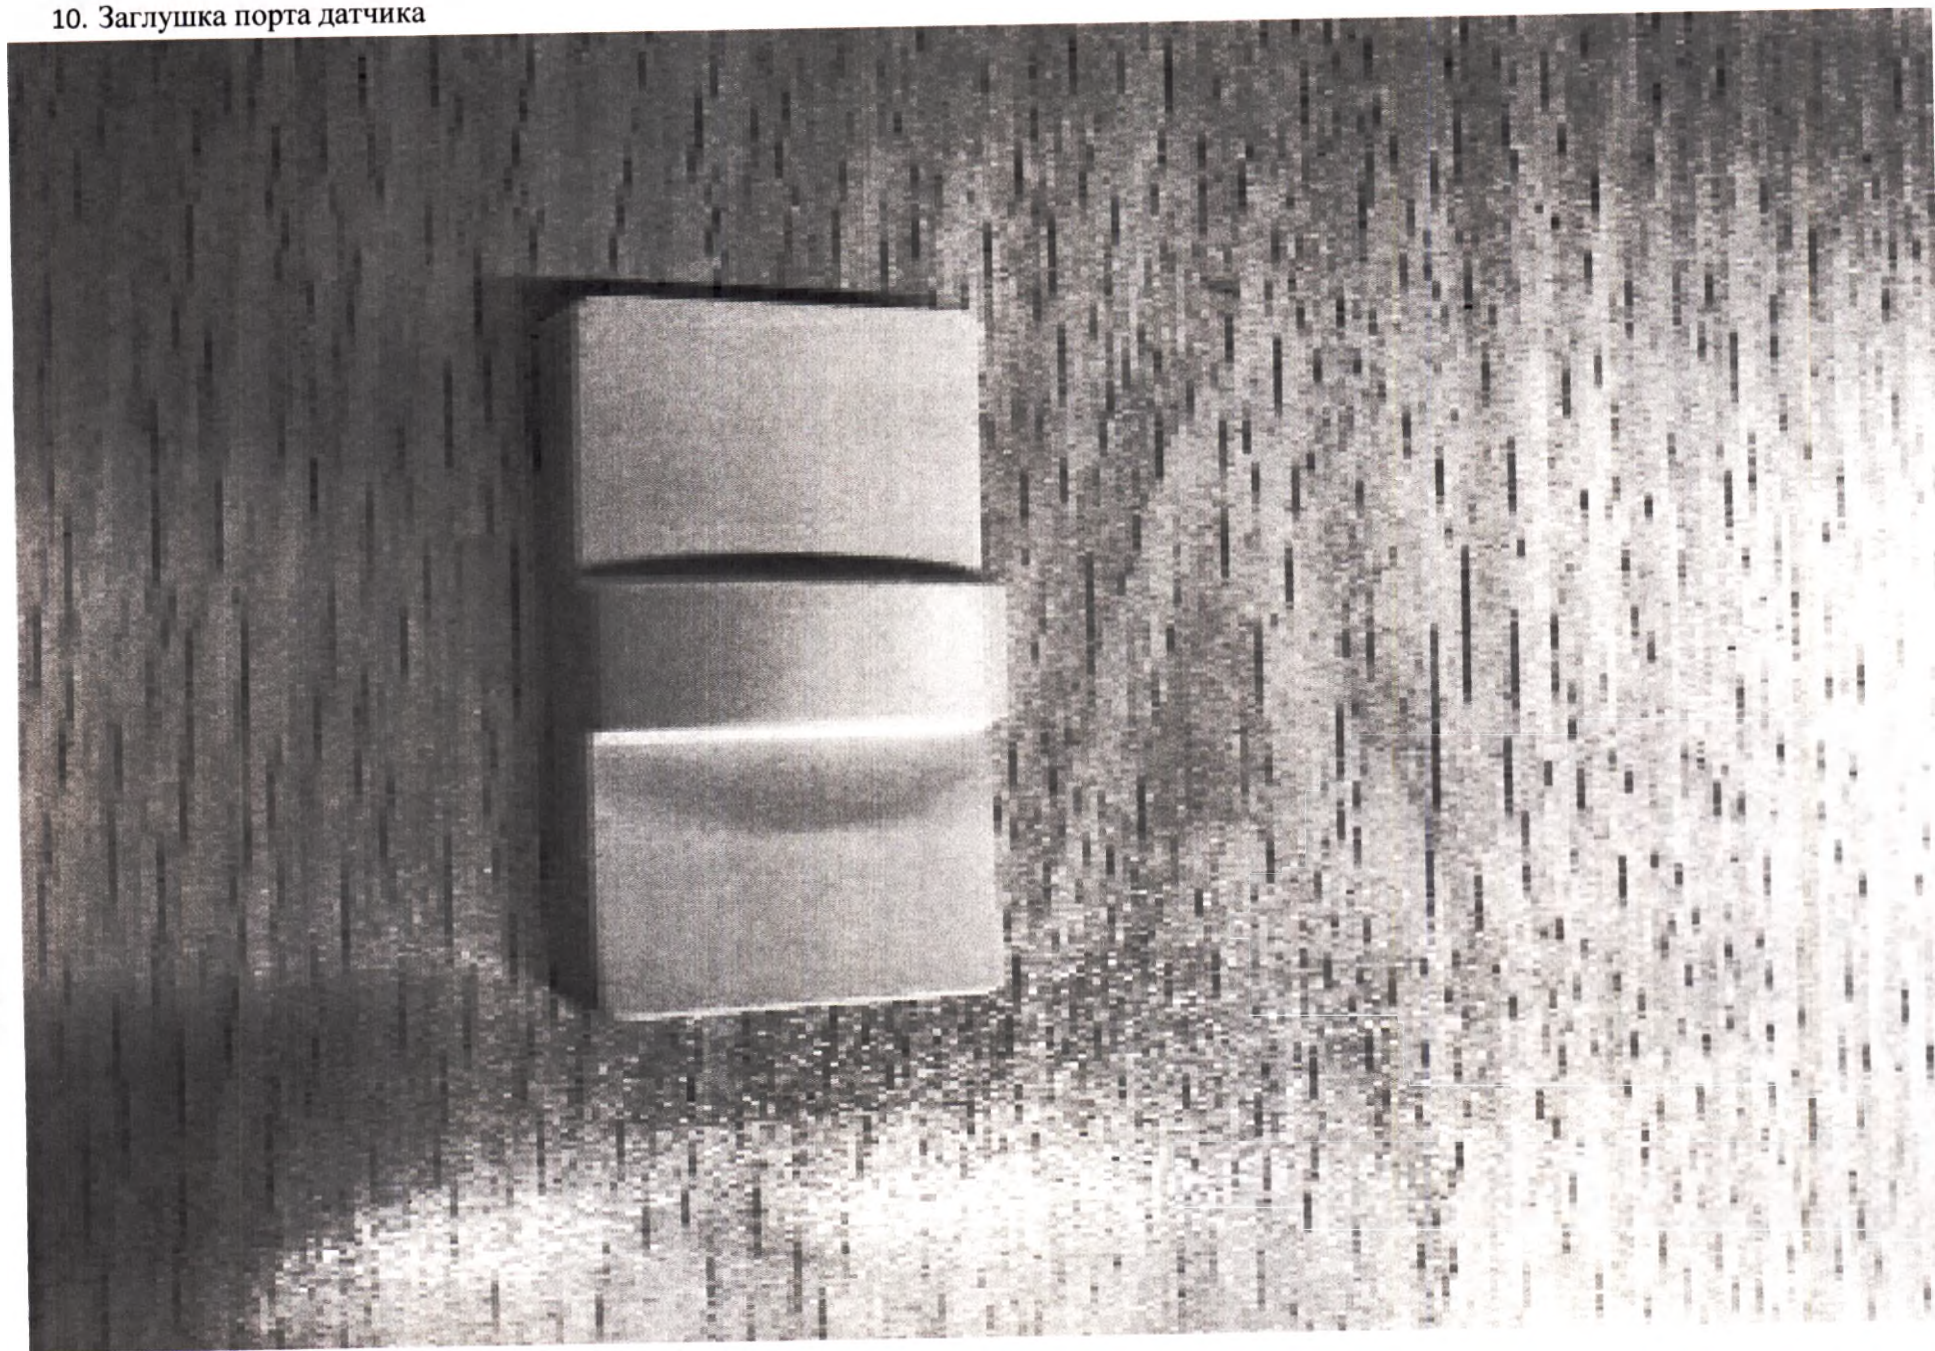



11. Шайба плоская

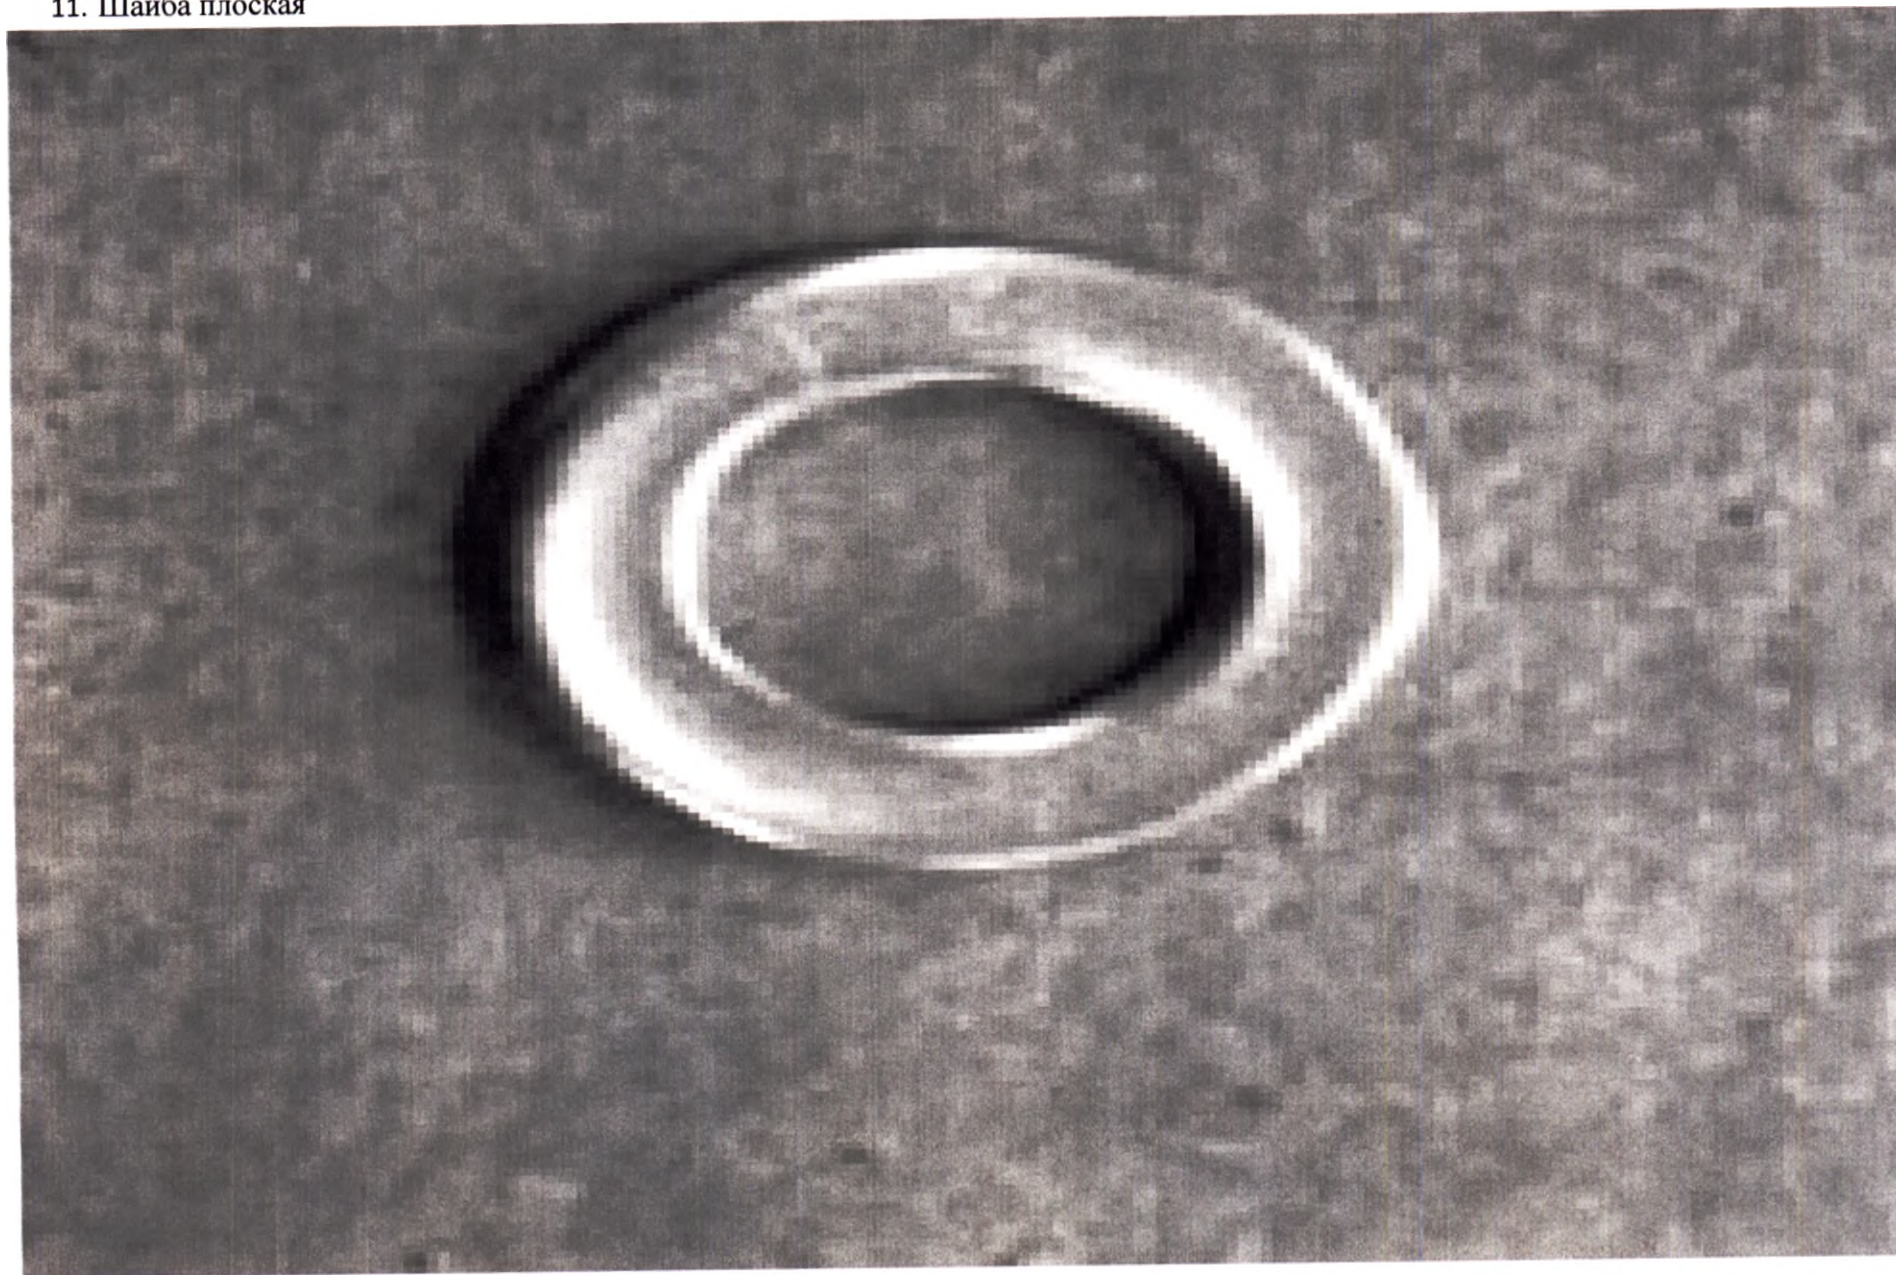

12. Шайба гроверная (пружинная)



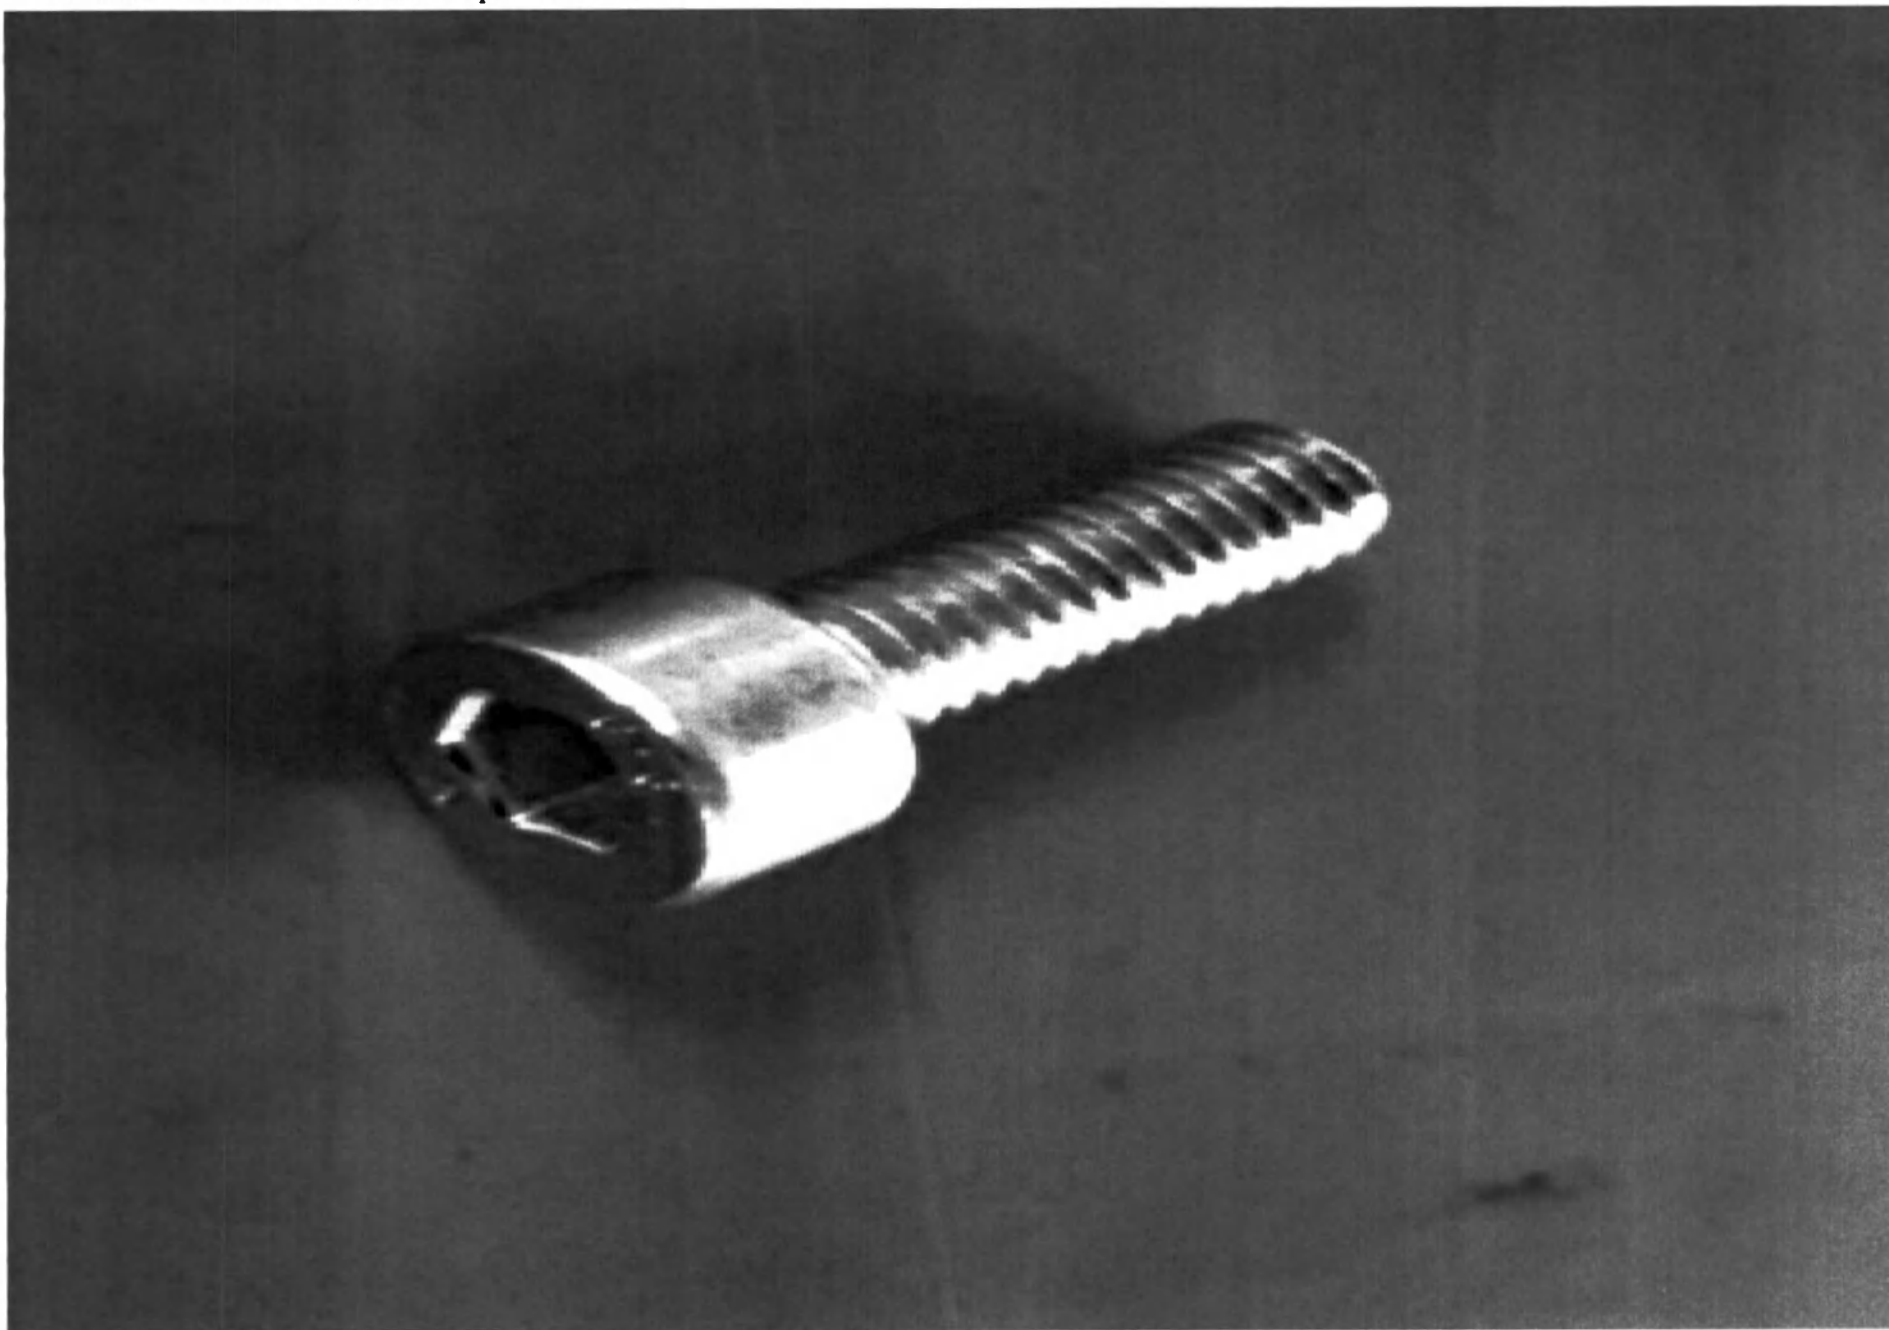


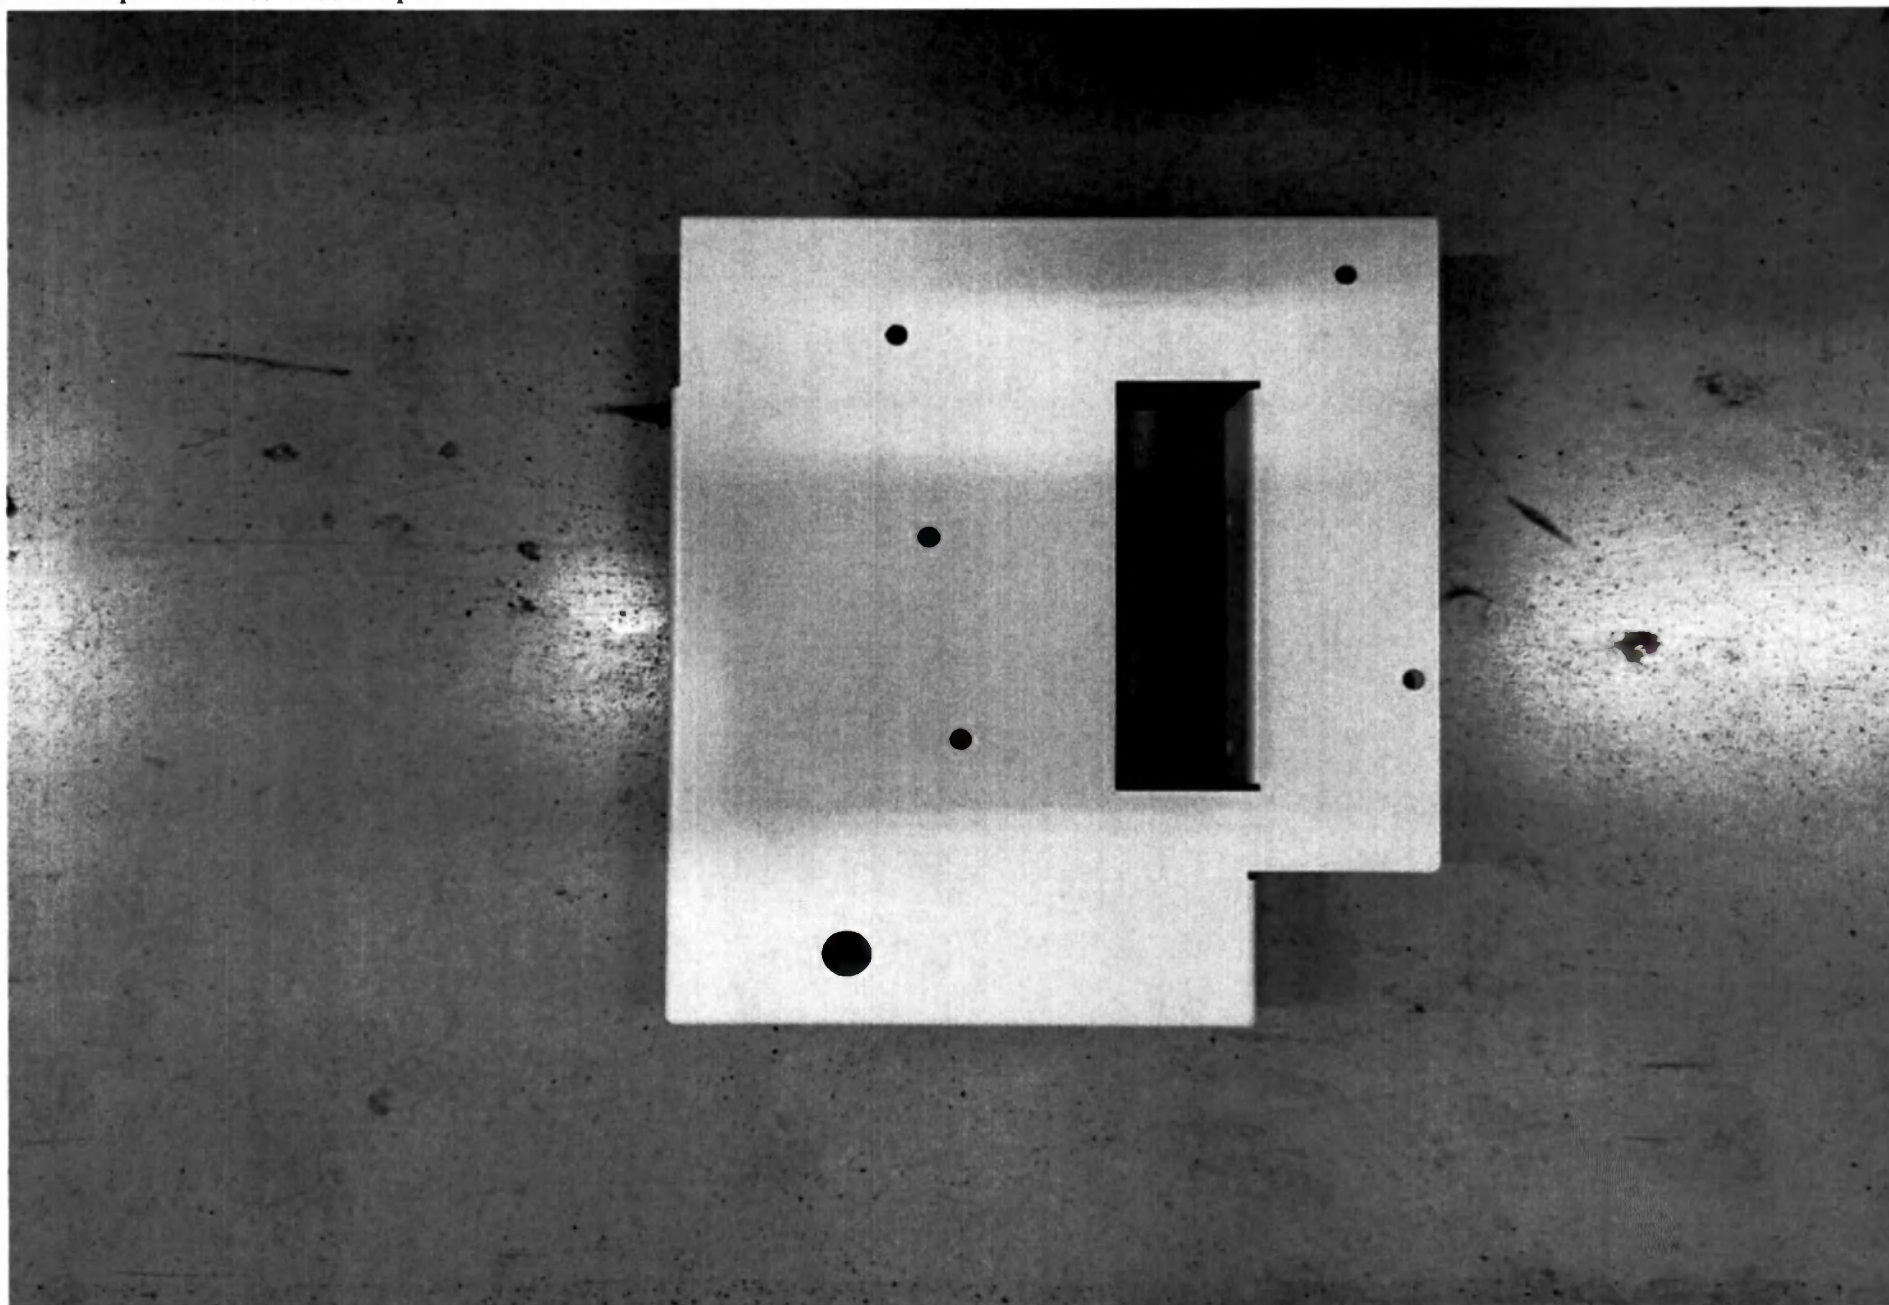


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку



16. Беспроводной USB-адаптер

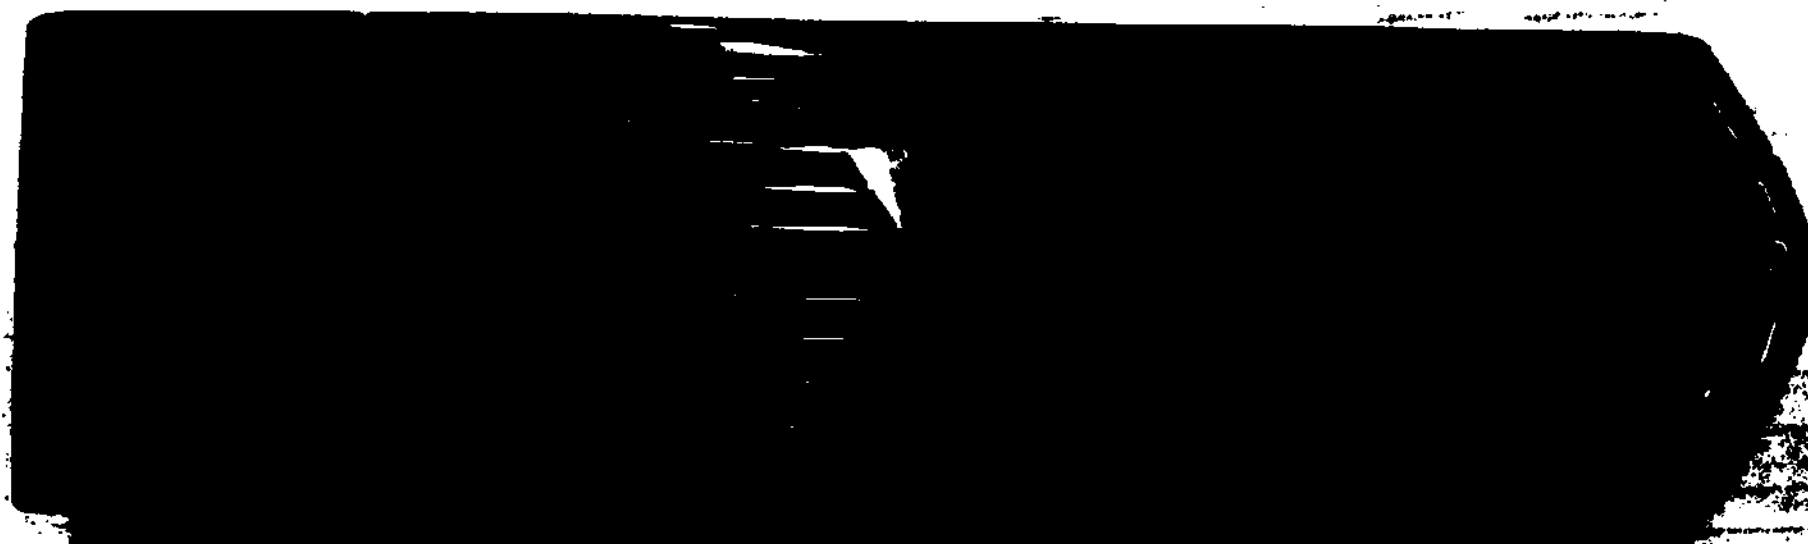



17. Модуль расширения портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов

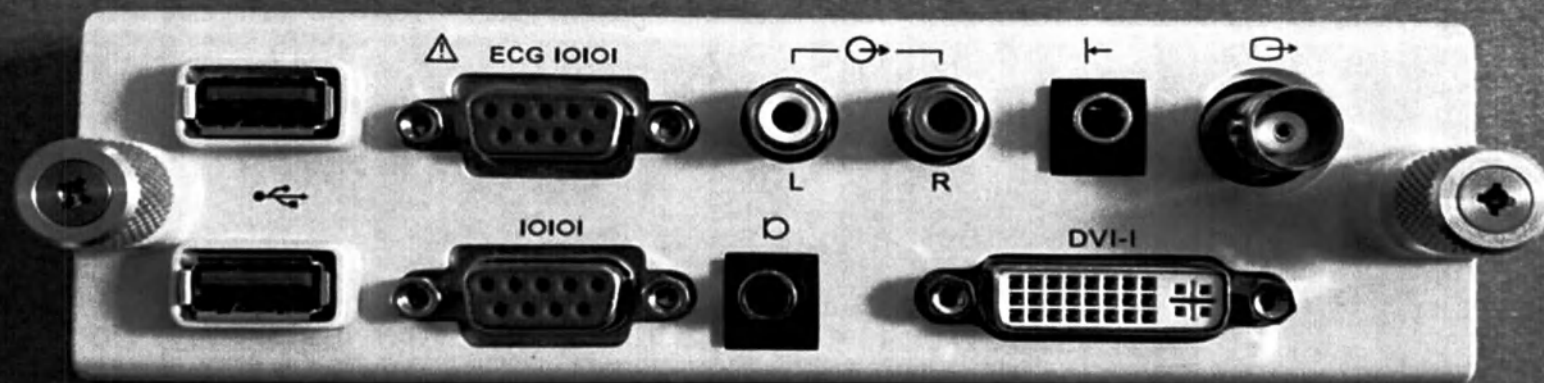


18. Кабель BNC



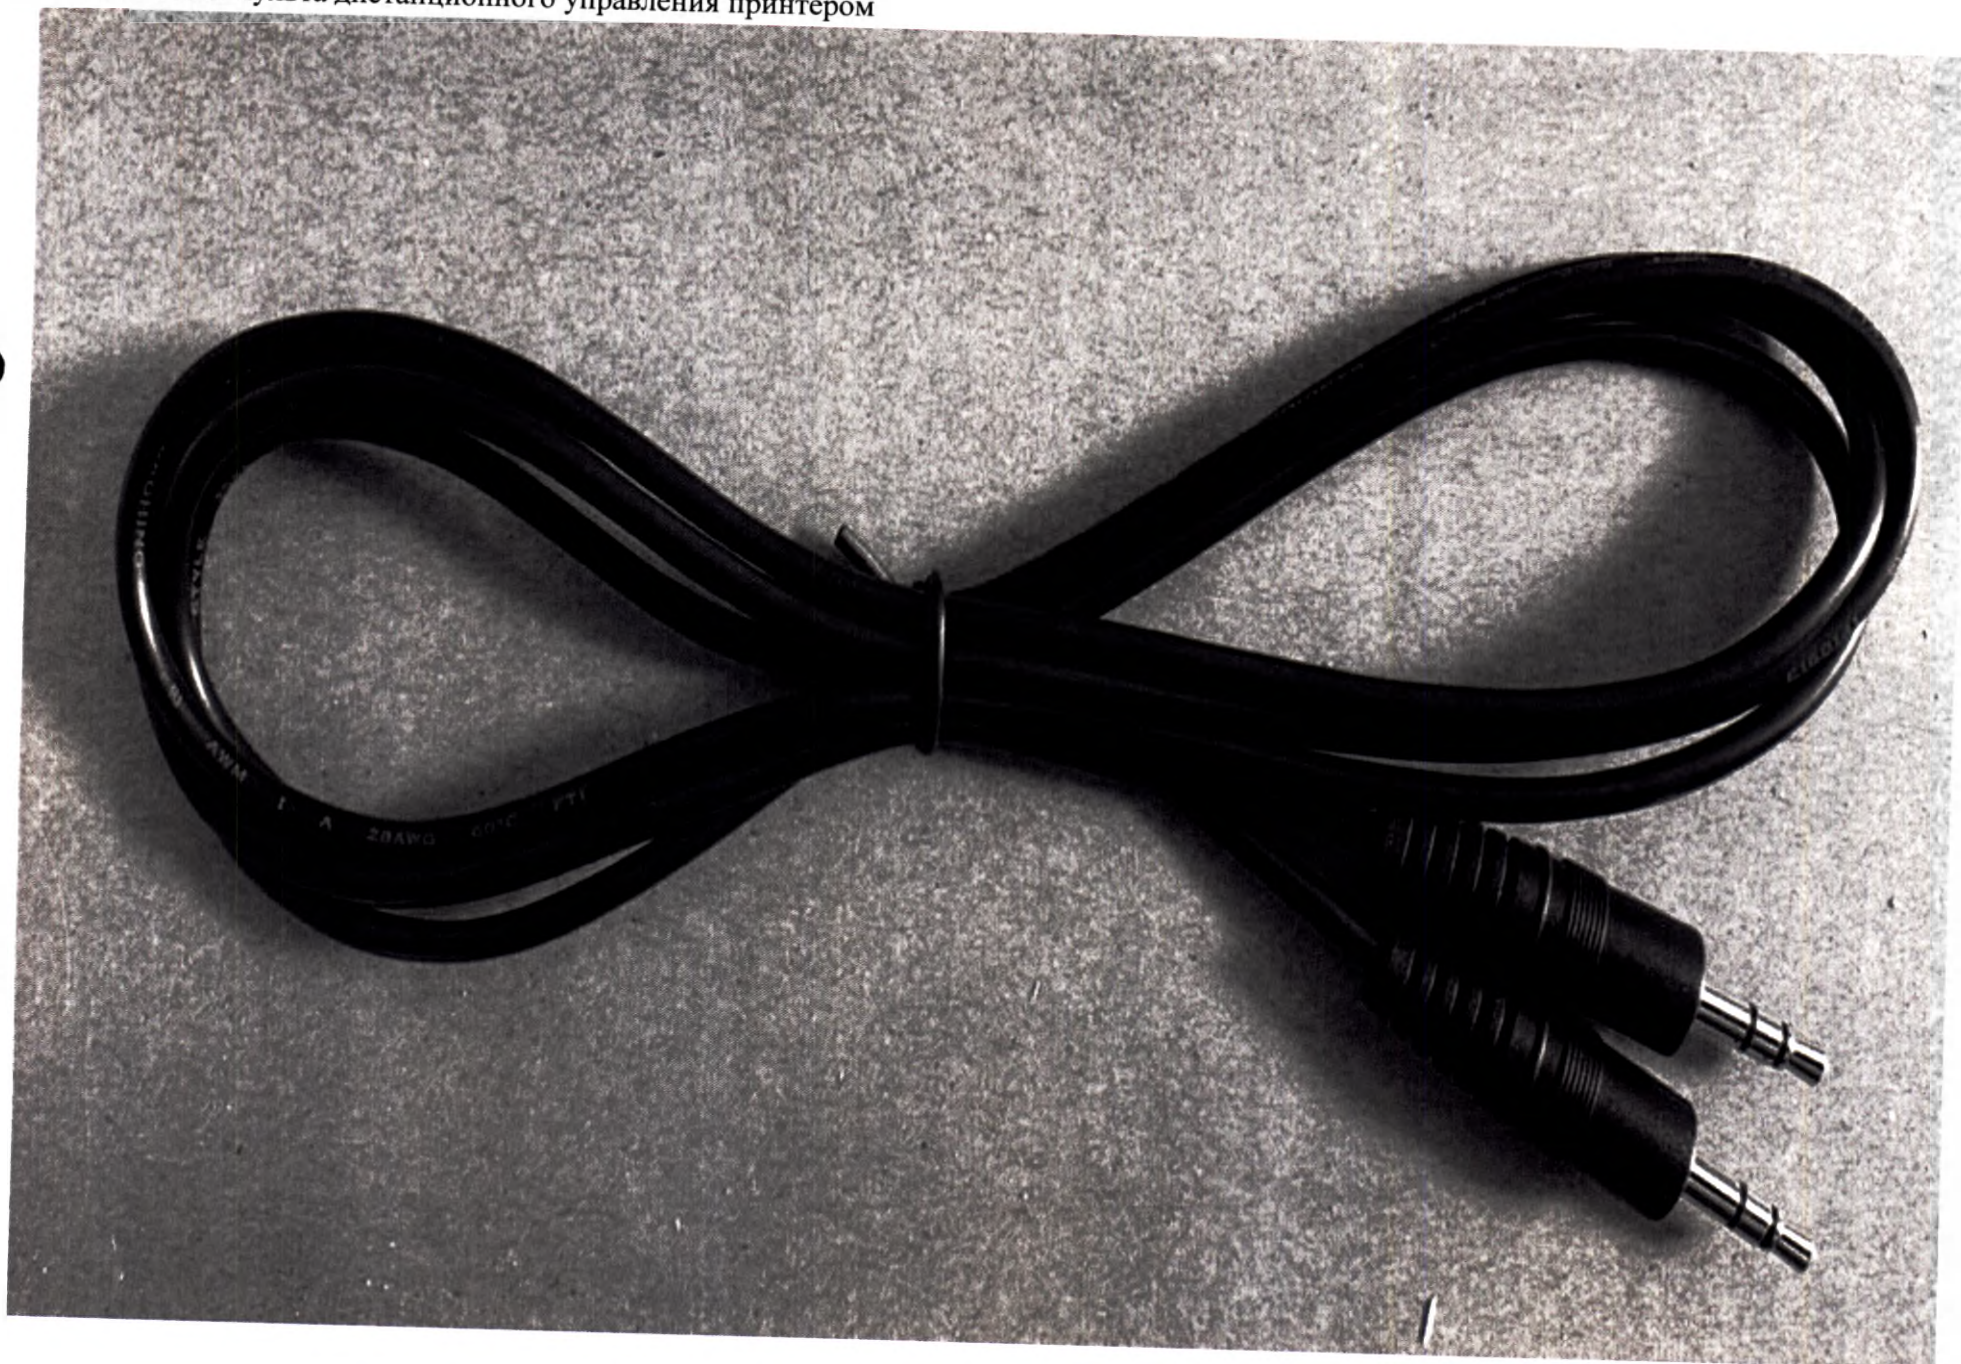

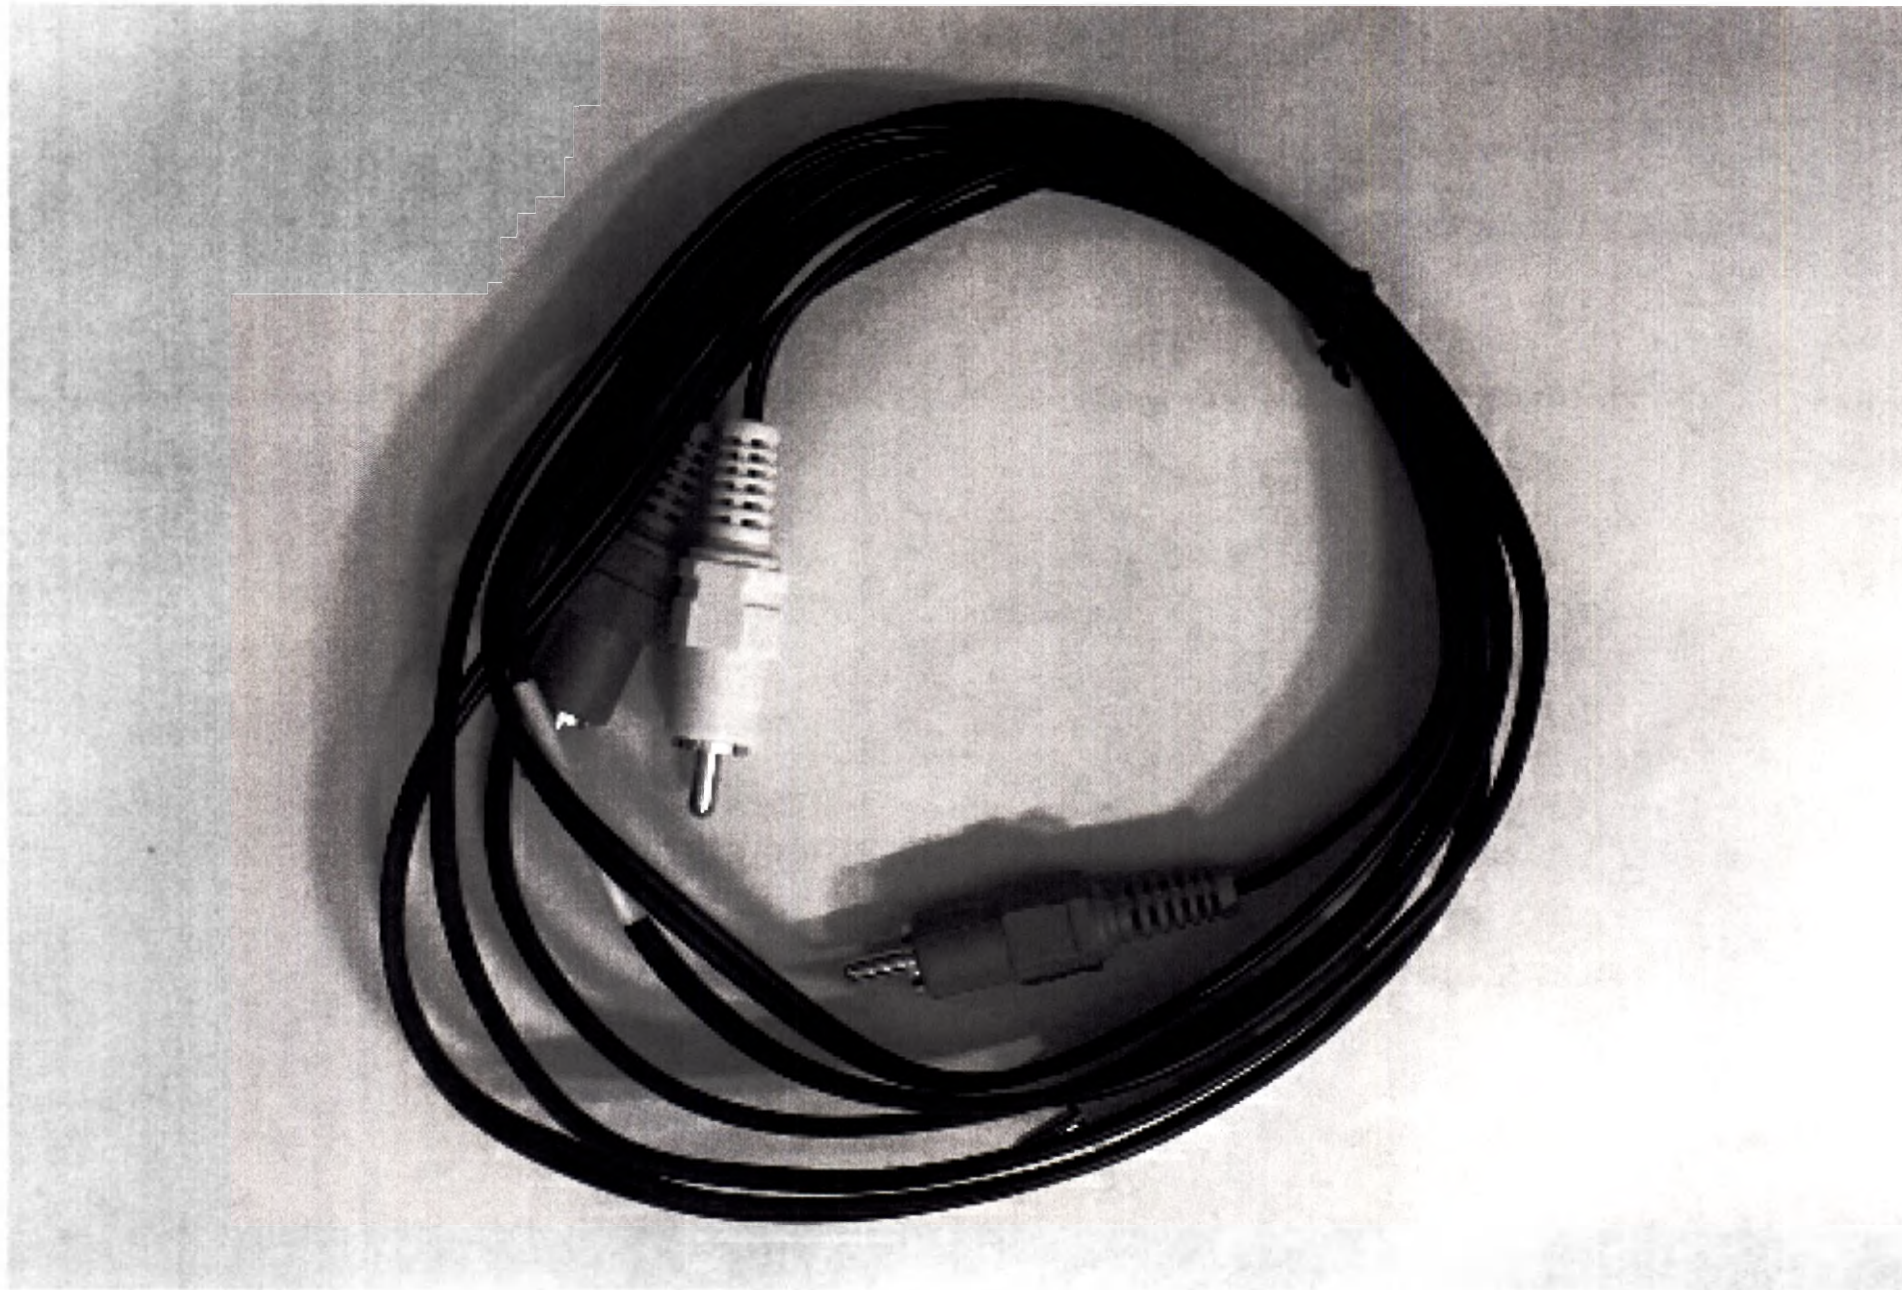



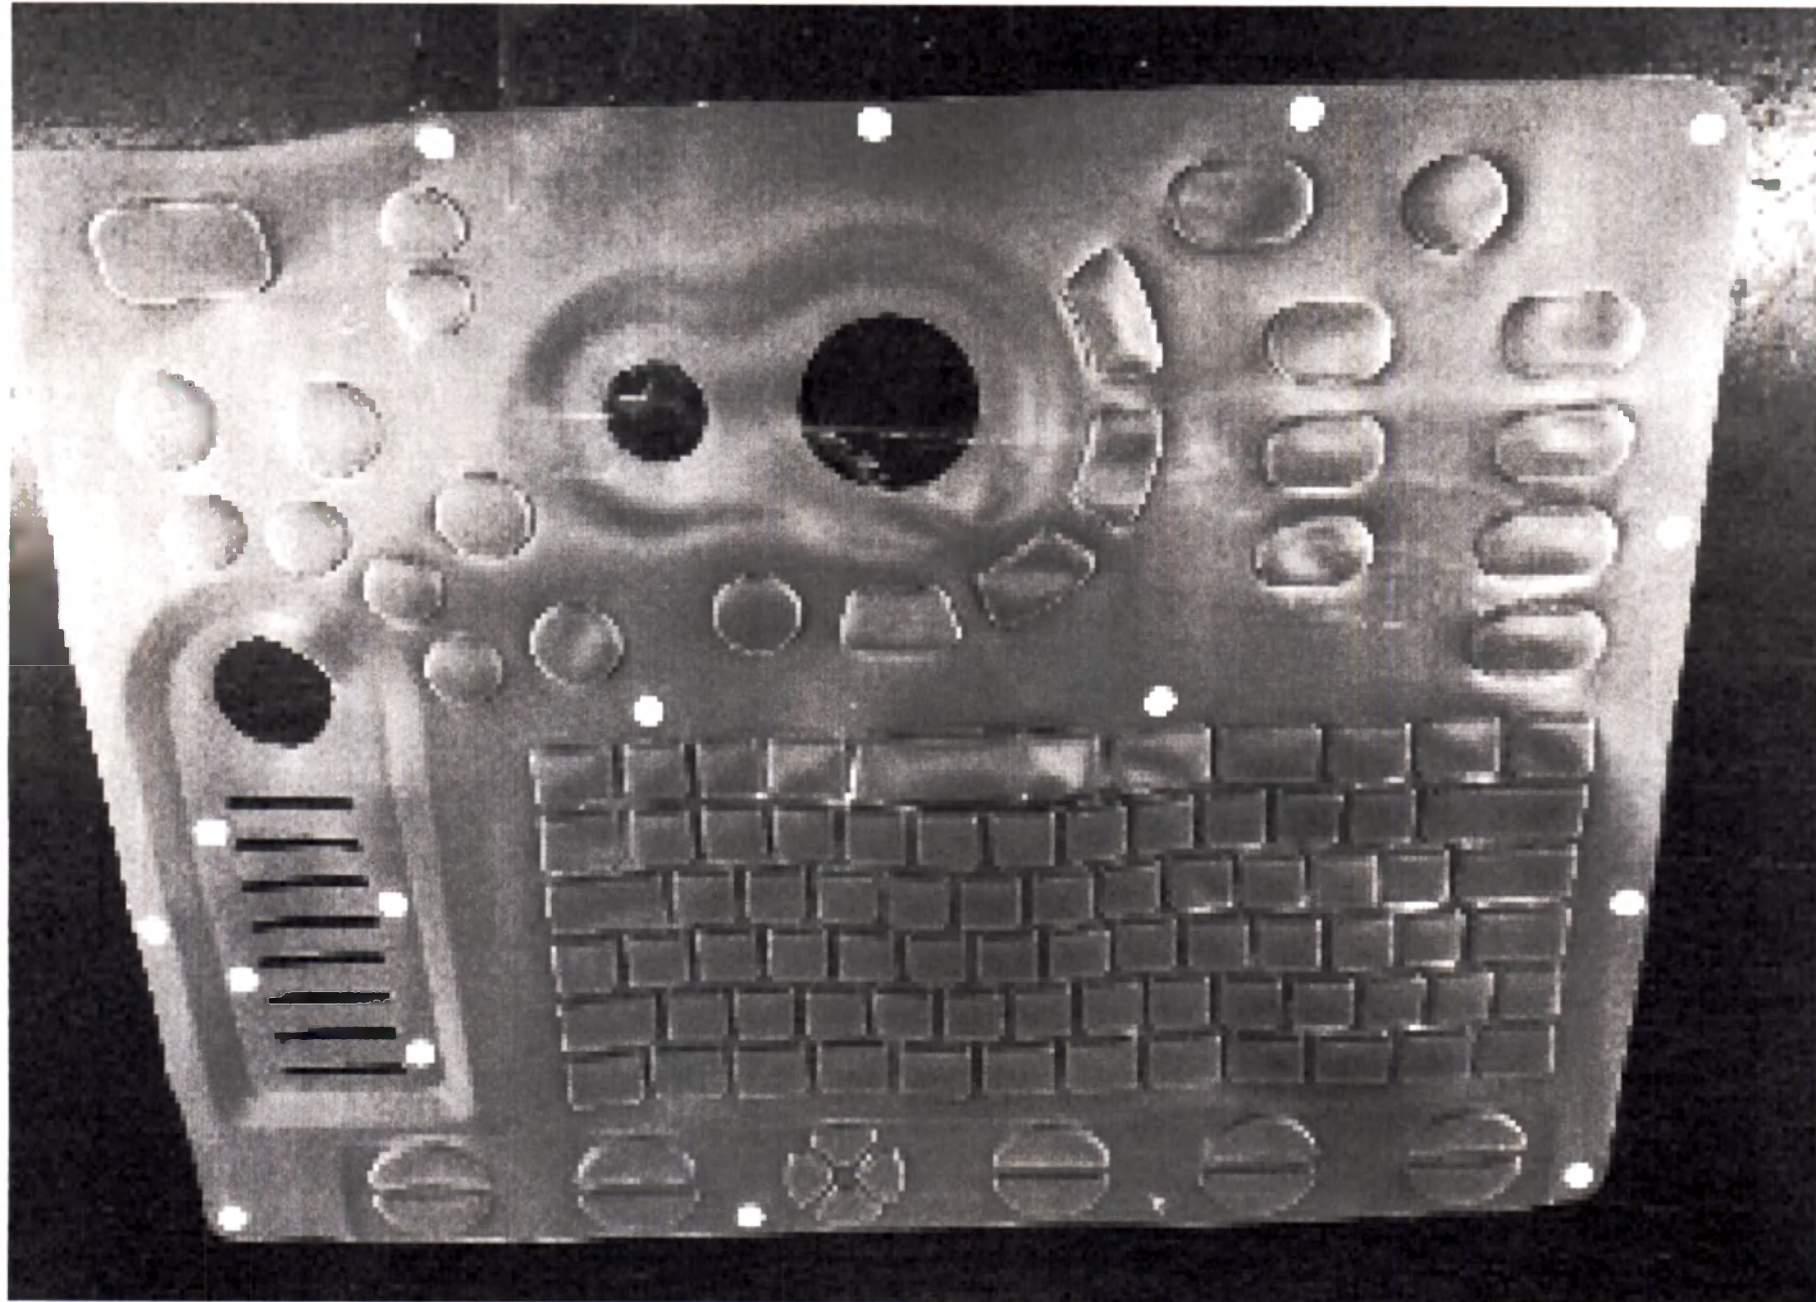



24. Датчики ультразвуковые

24.1 Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s




24.2. Датчик ультразвуковой конвексный 3C5s





24.3. Датчик ультразвуковой конвексный объемный 4CD4s




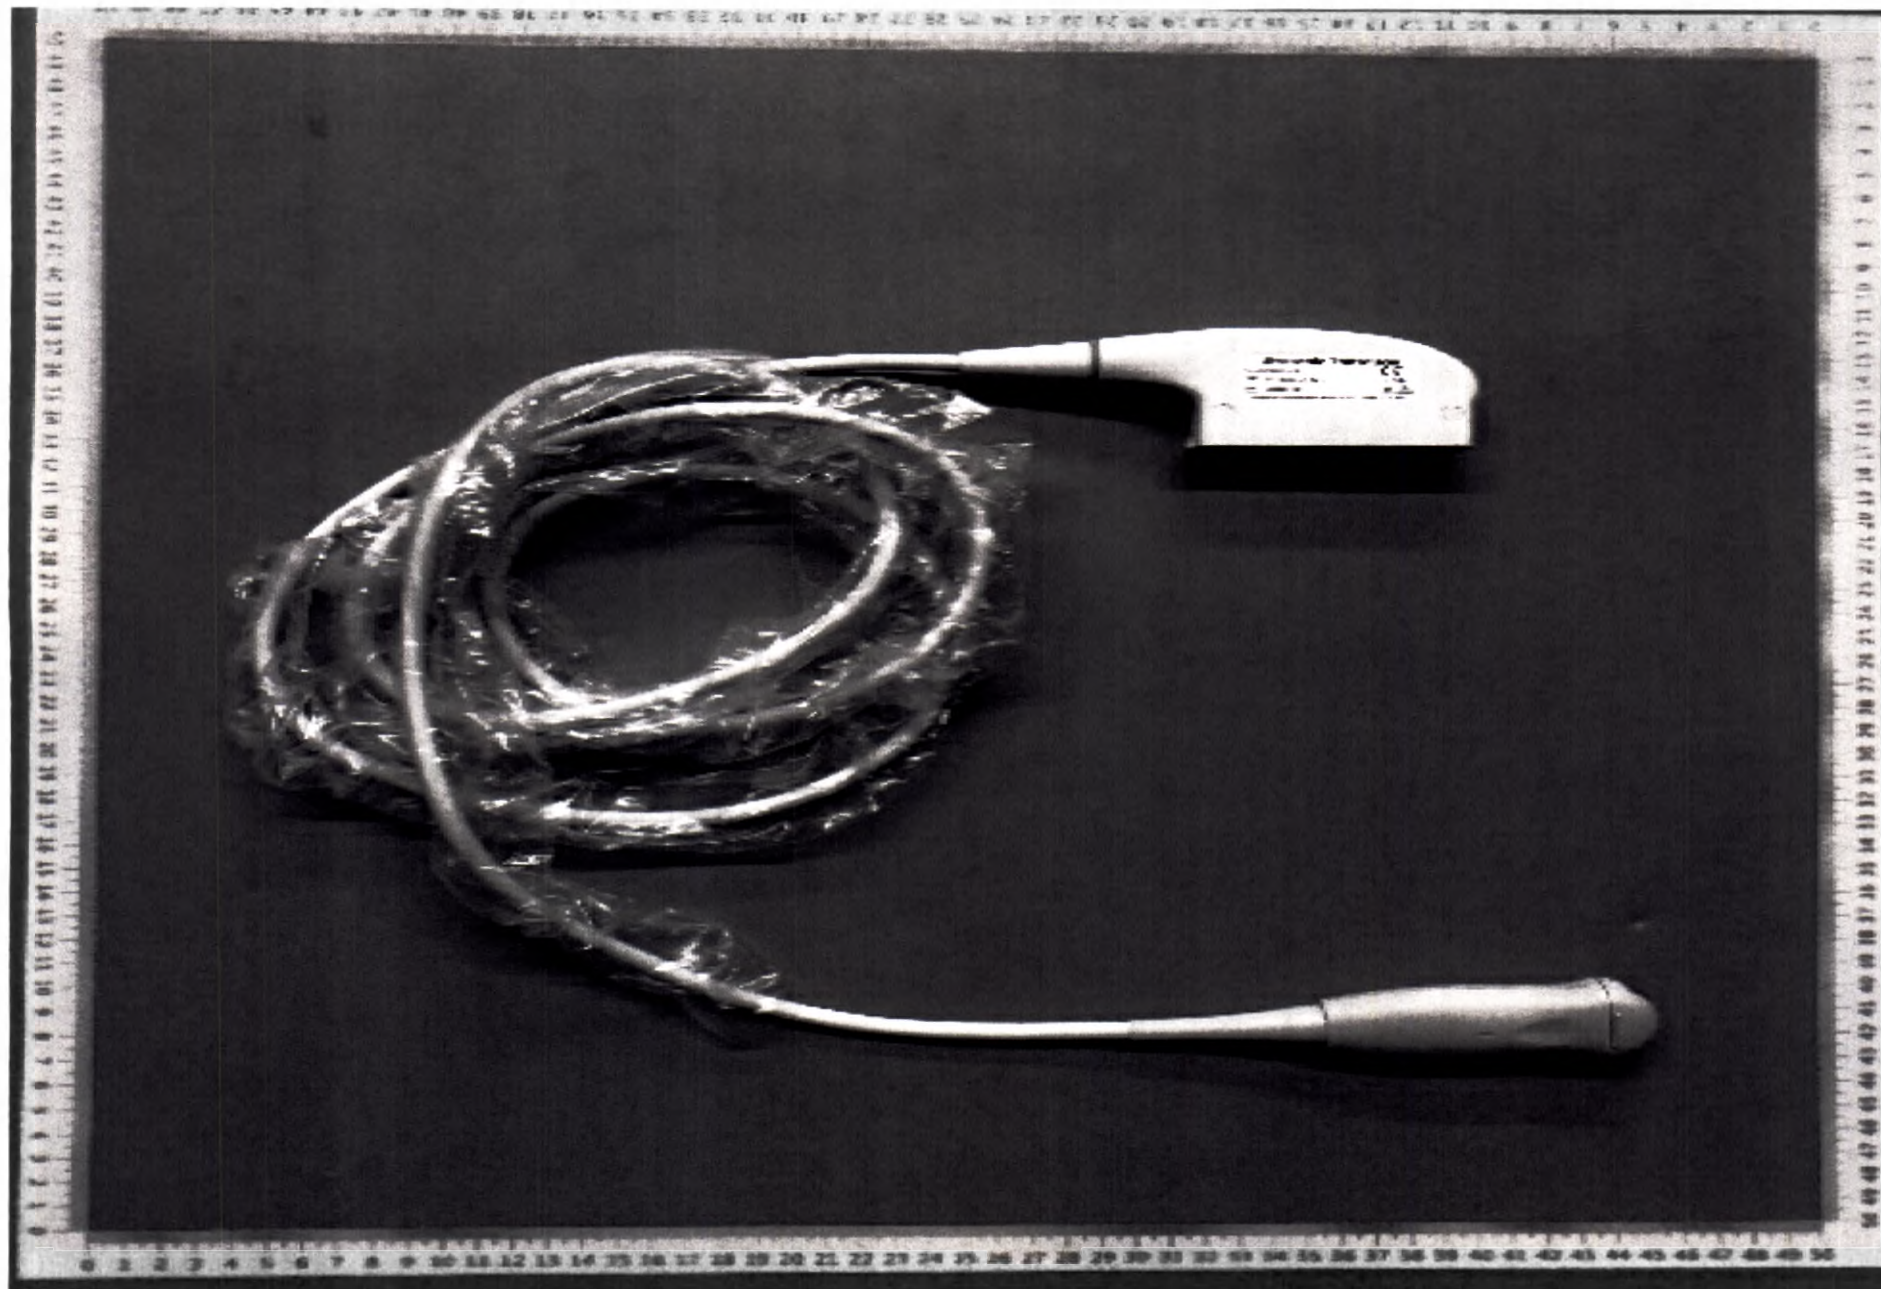




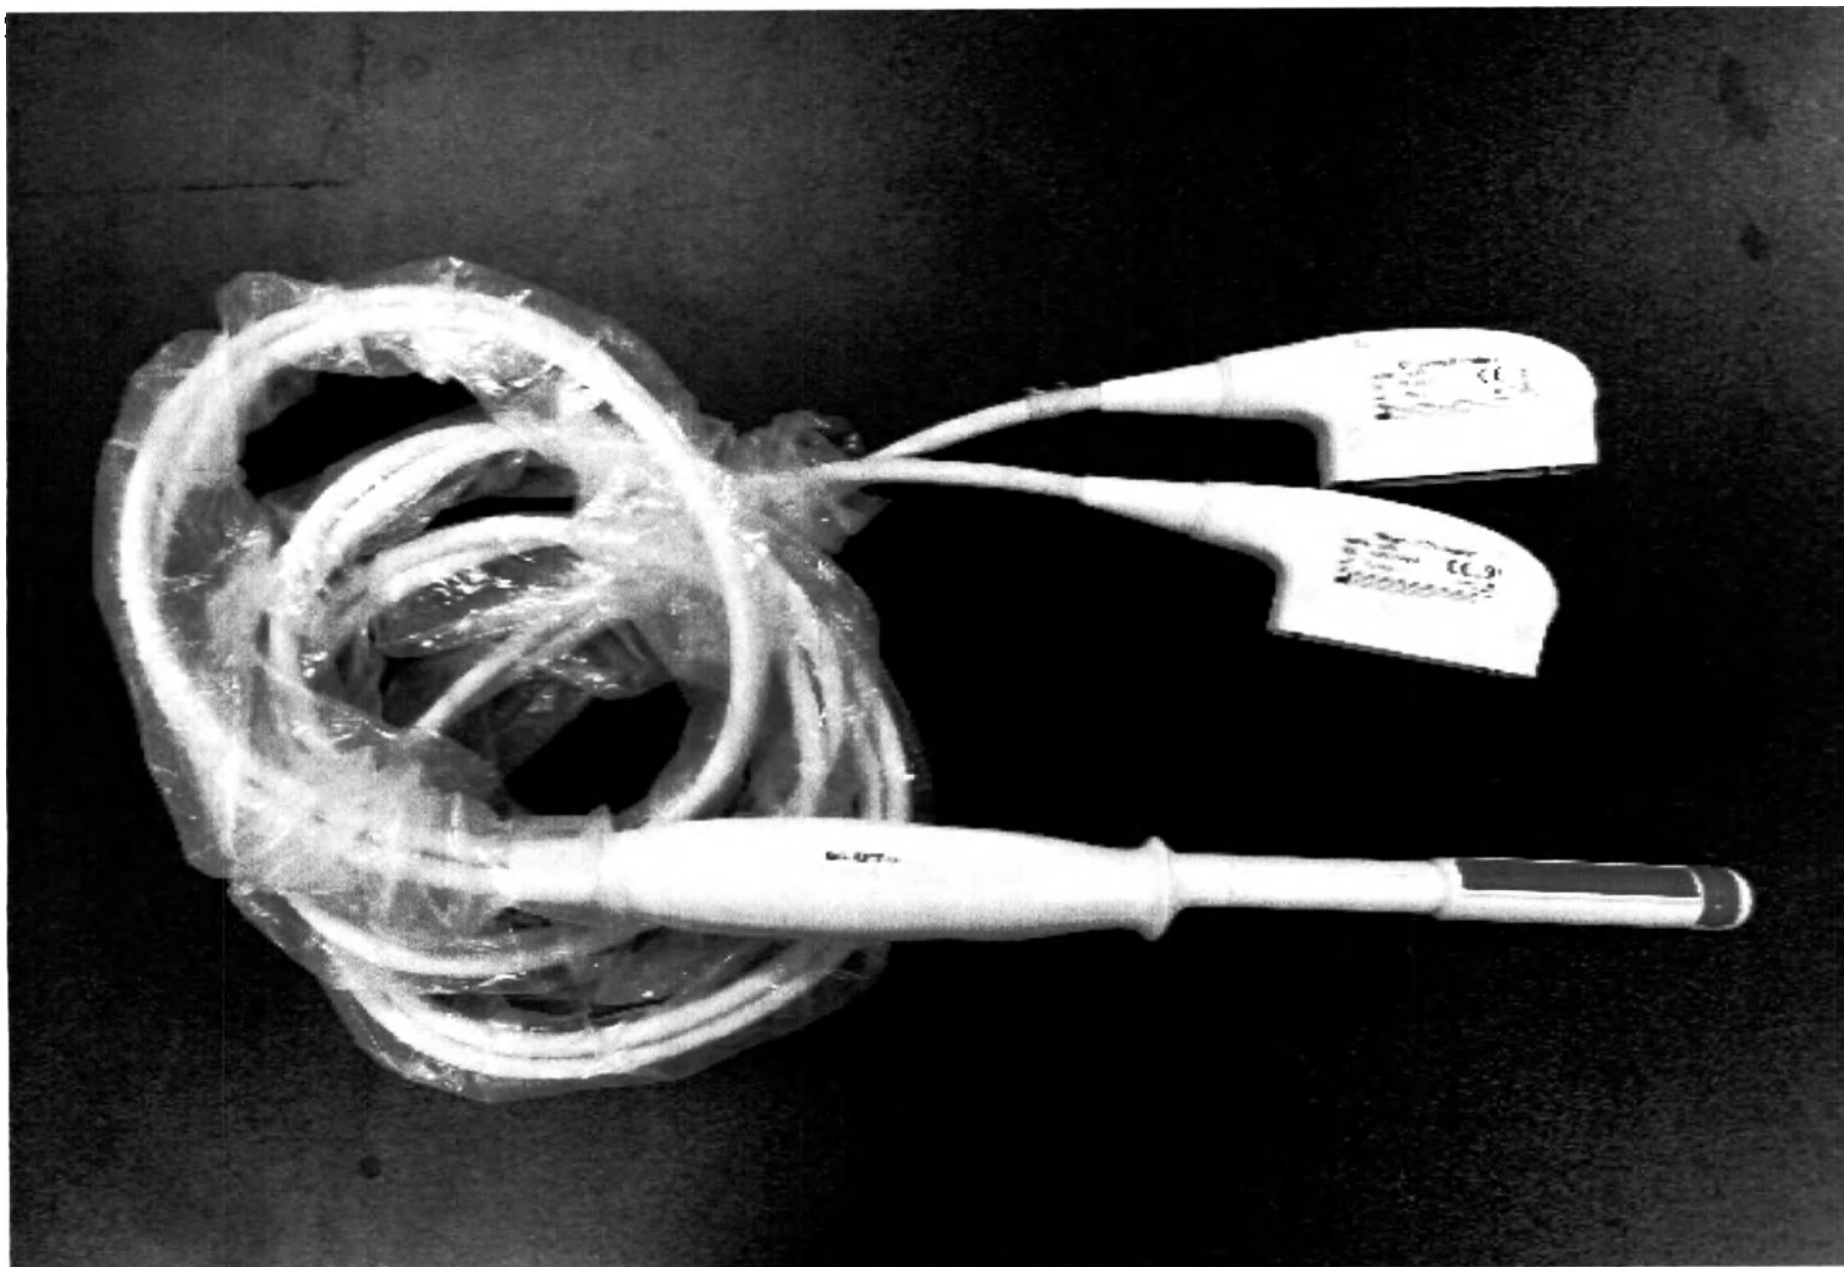

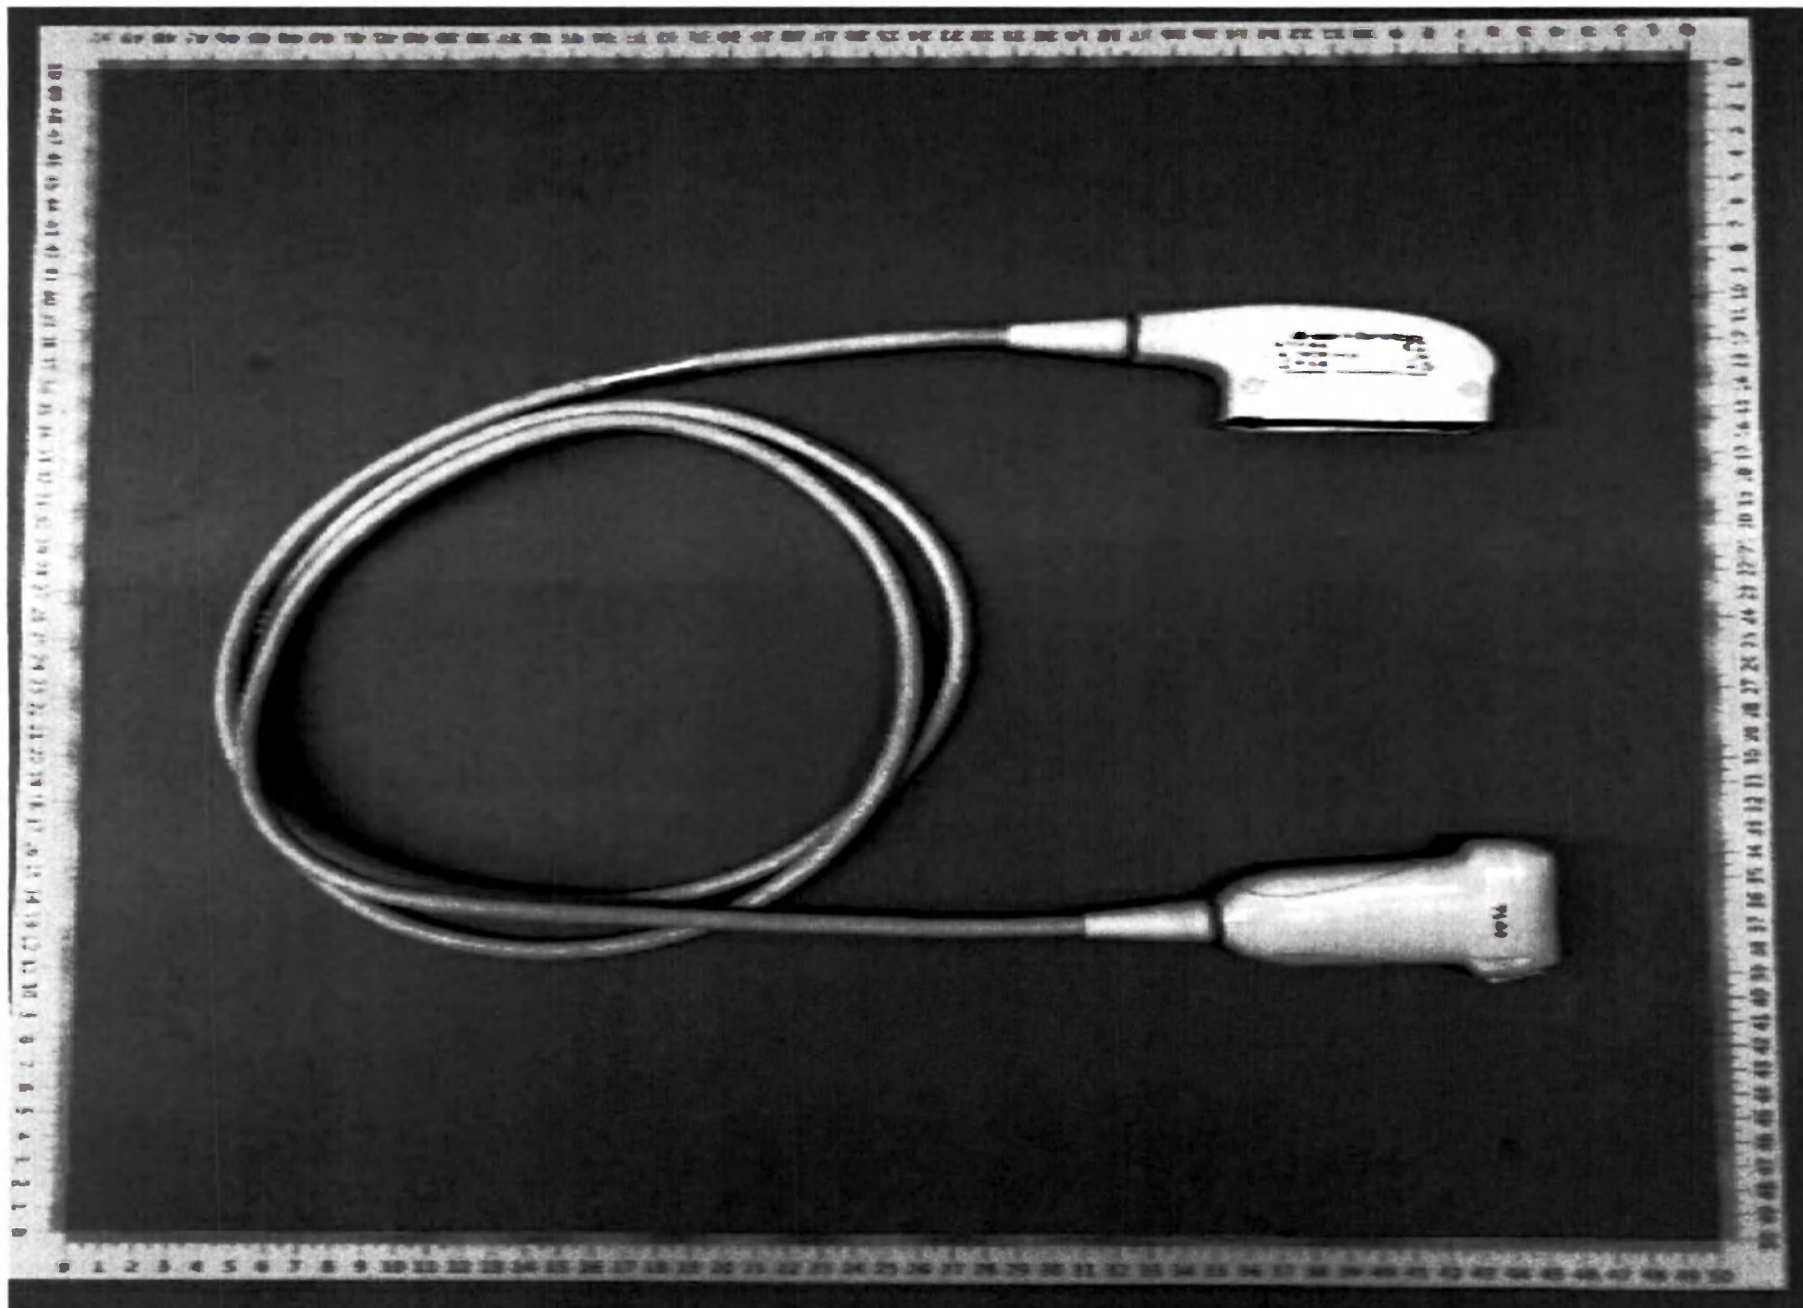


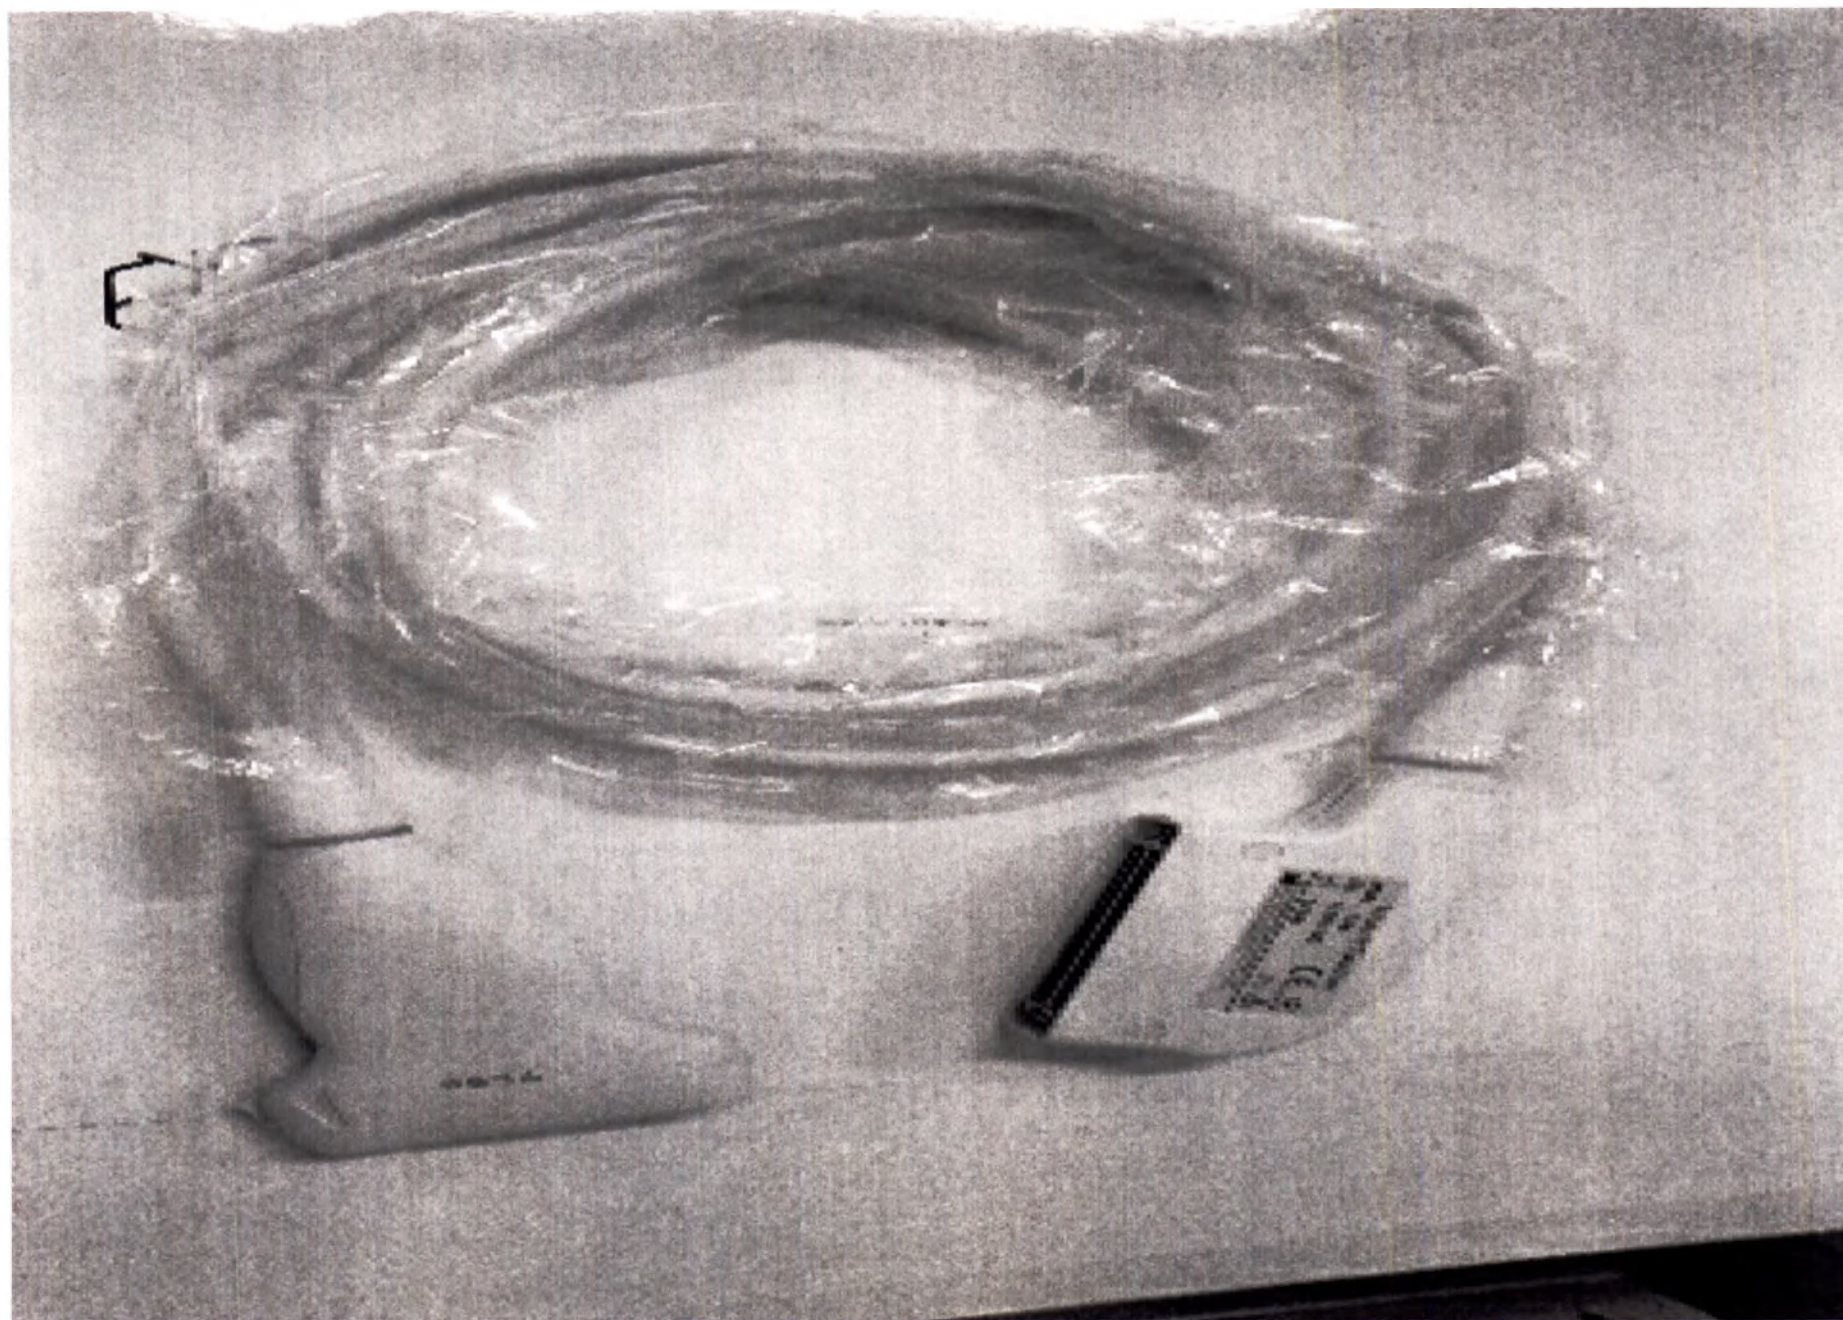




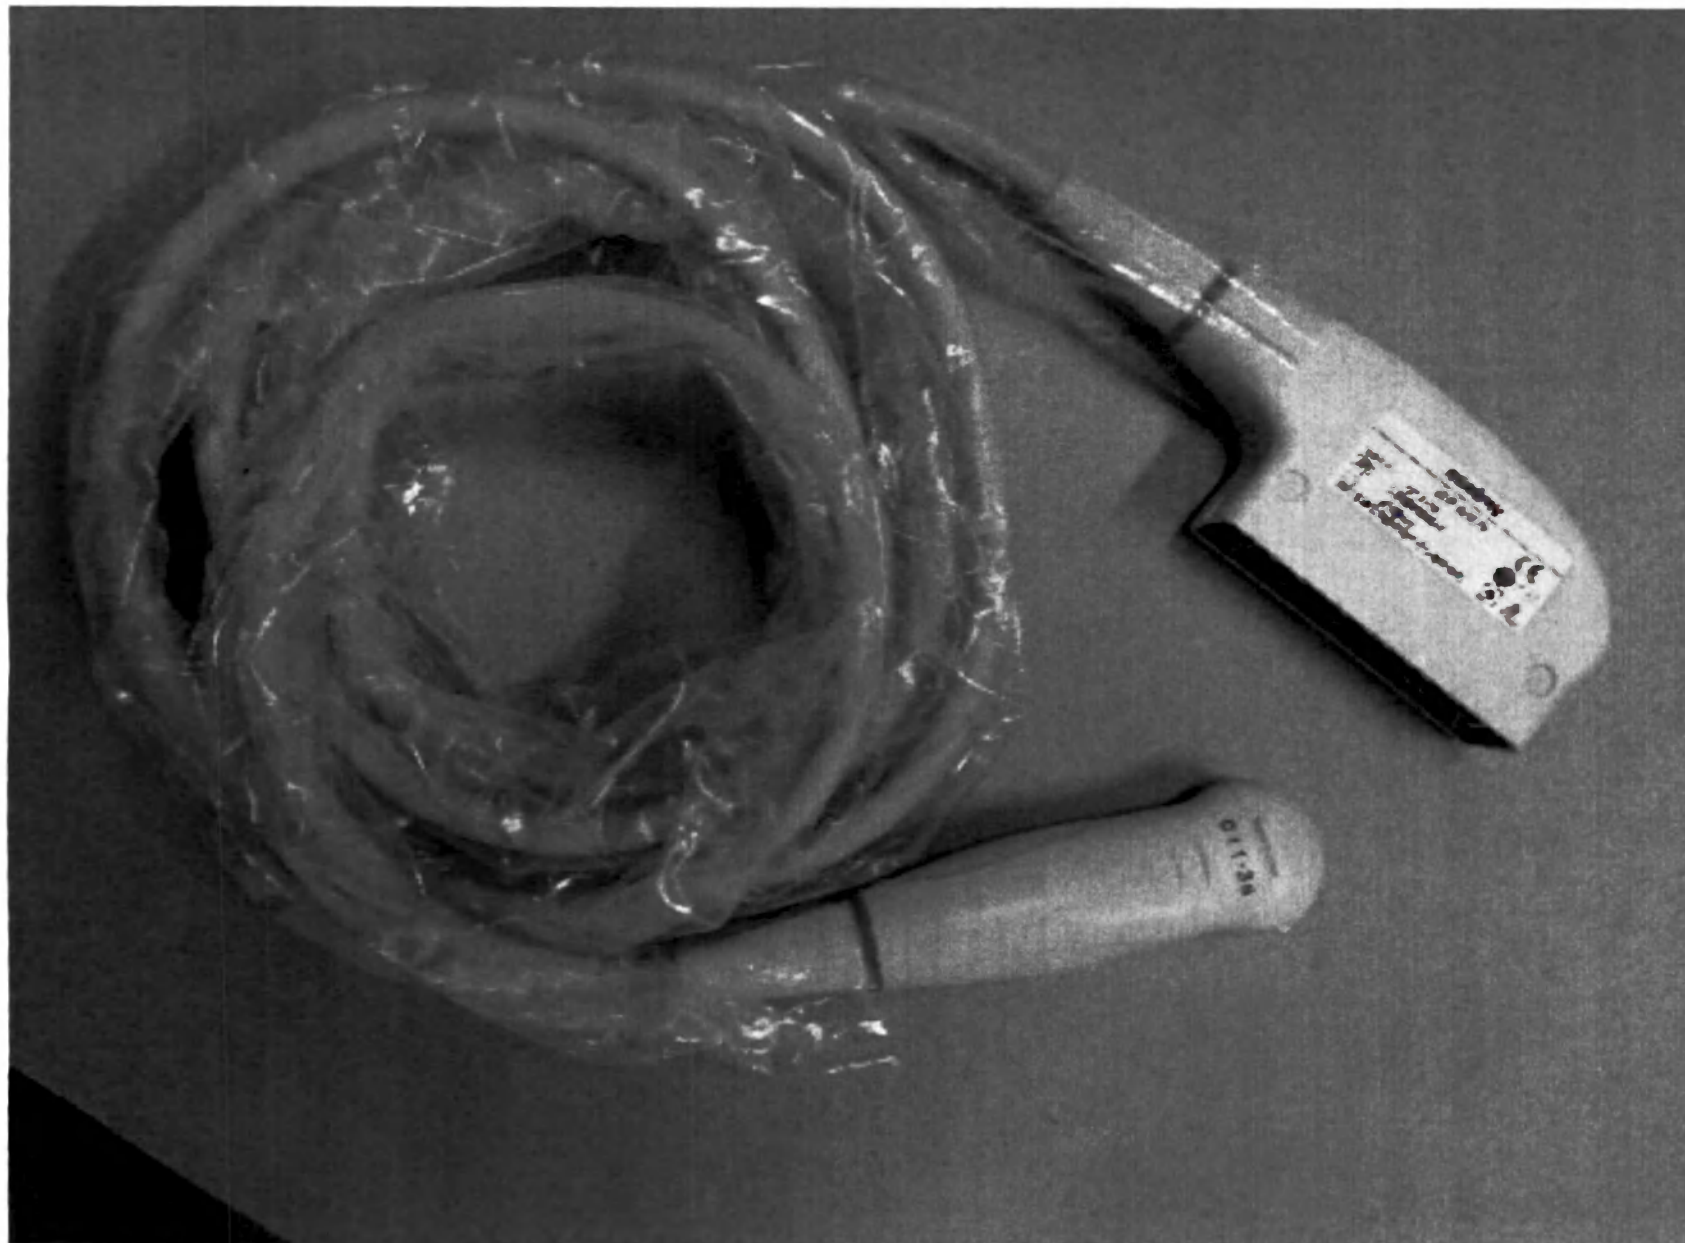




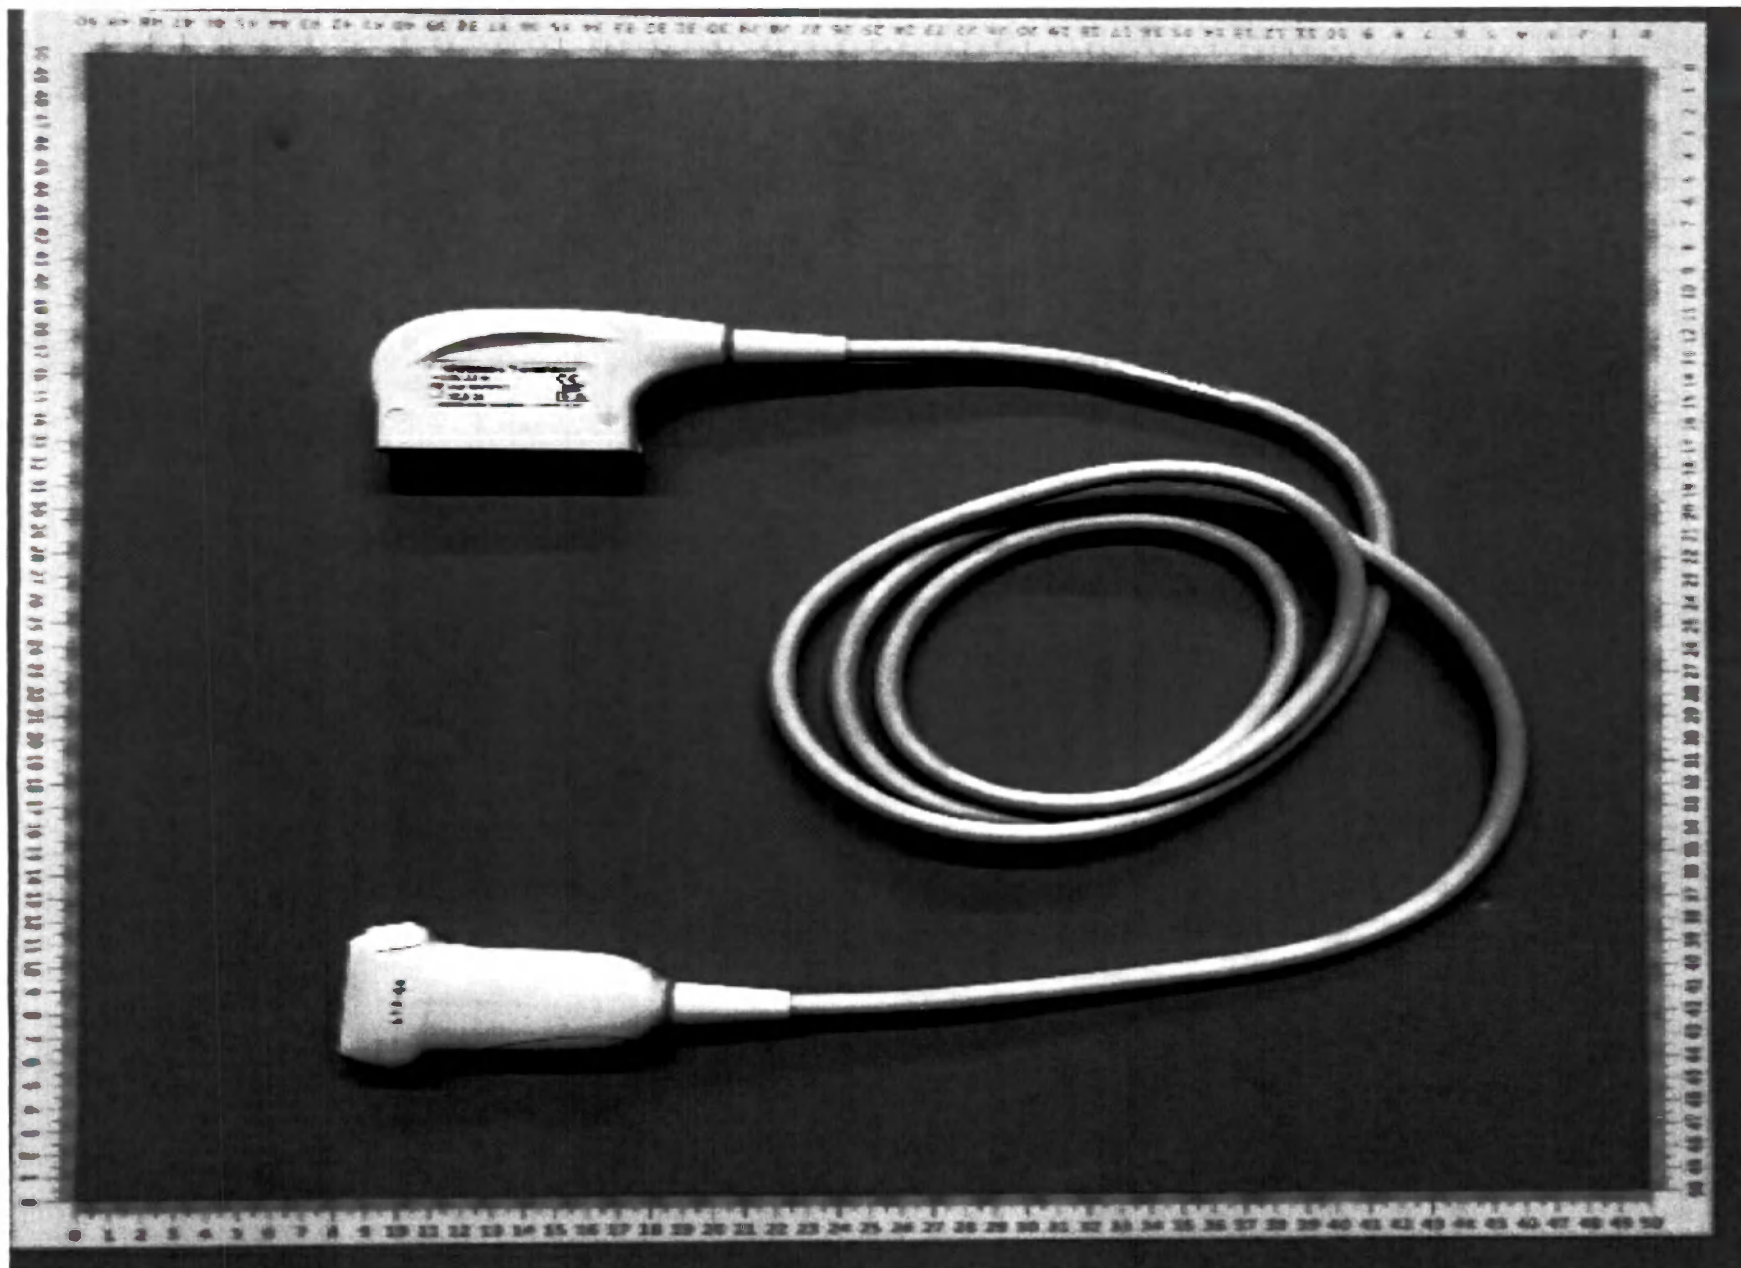


24.13. Датчик ультразвуковой линейный L12-4s

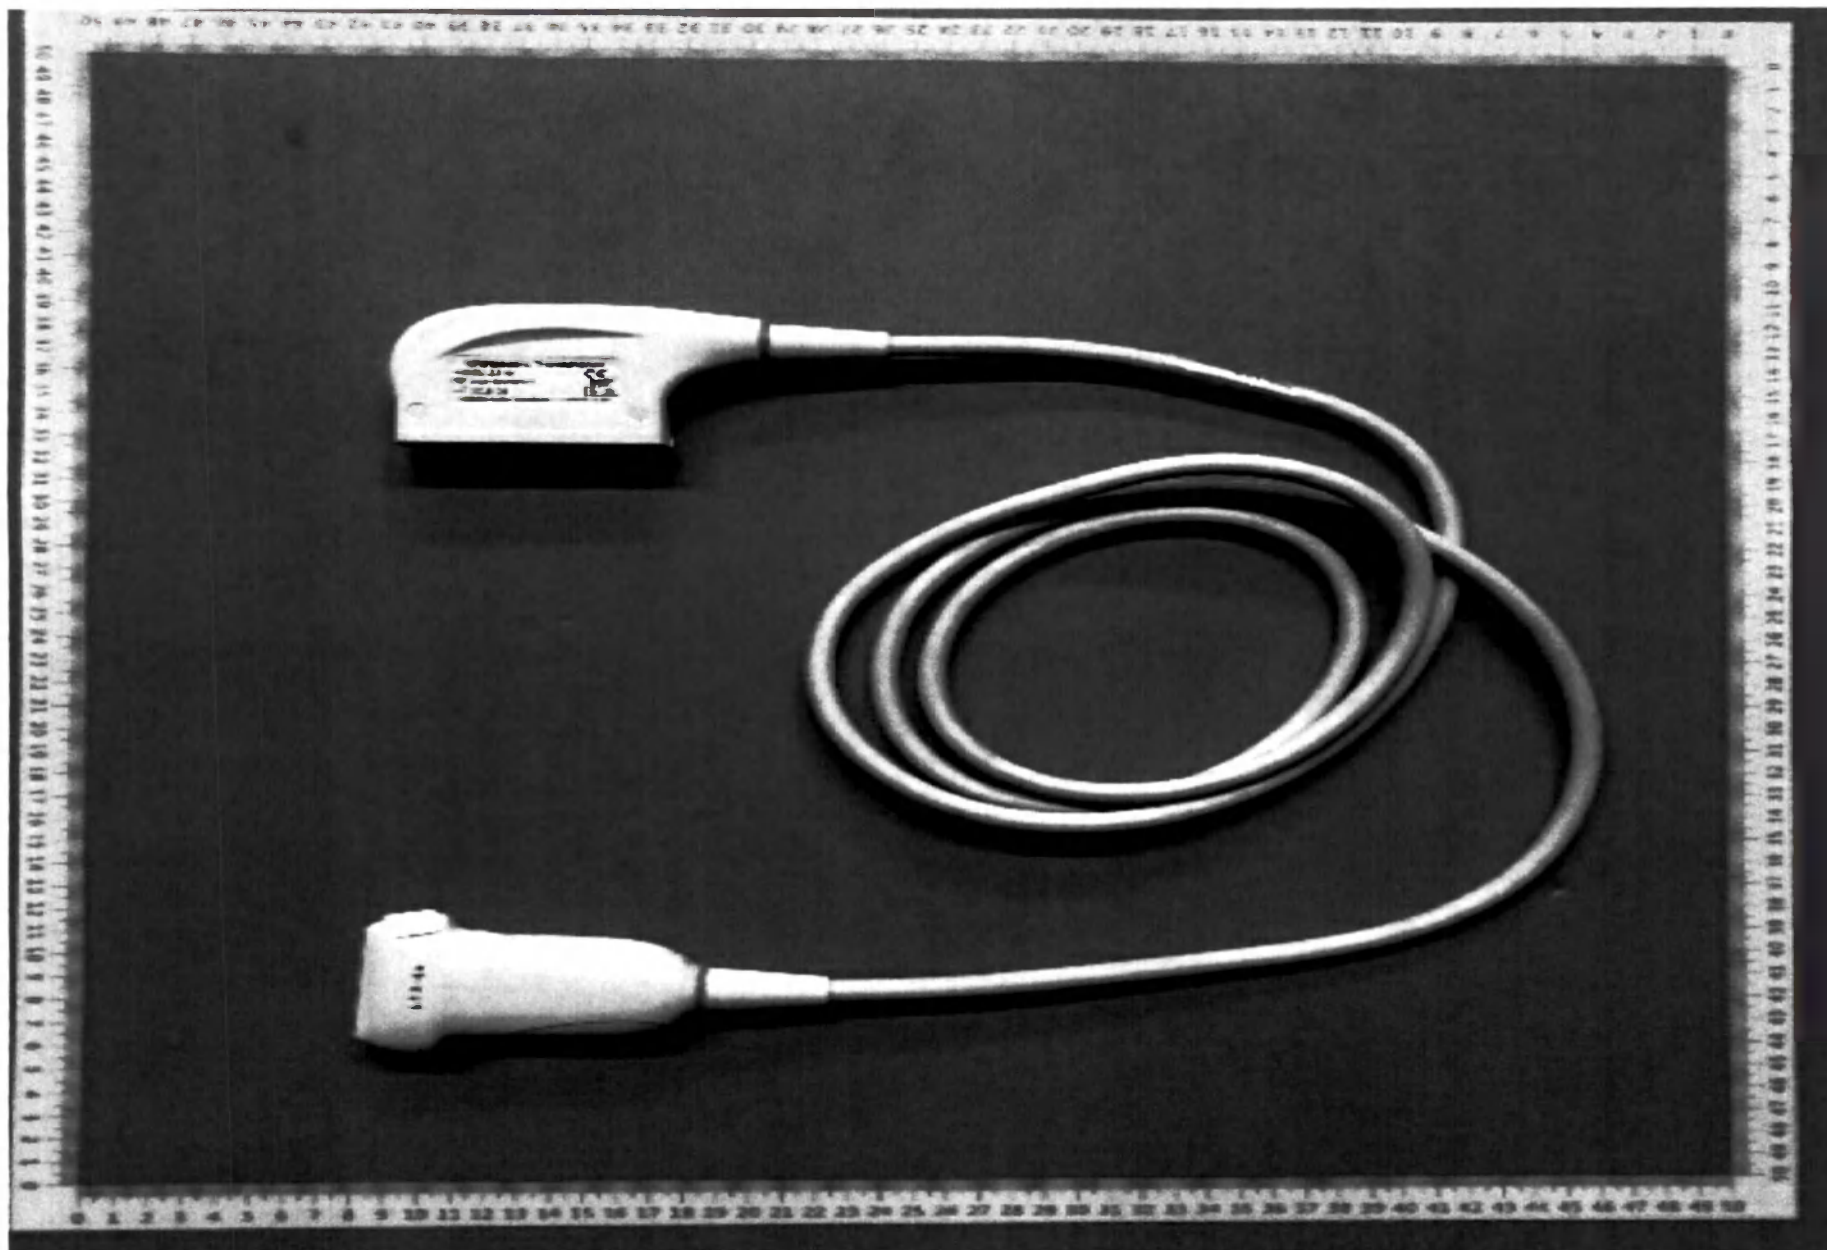




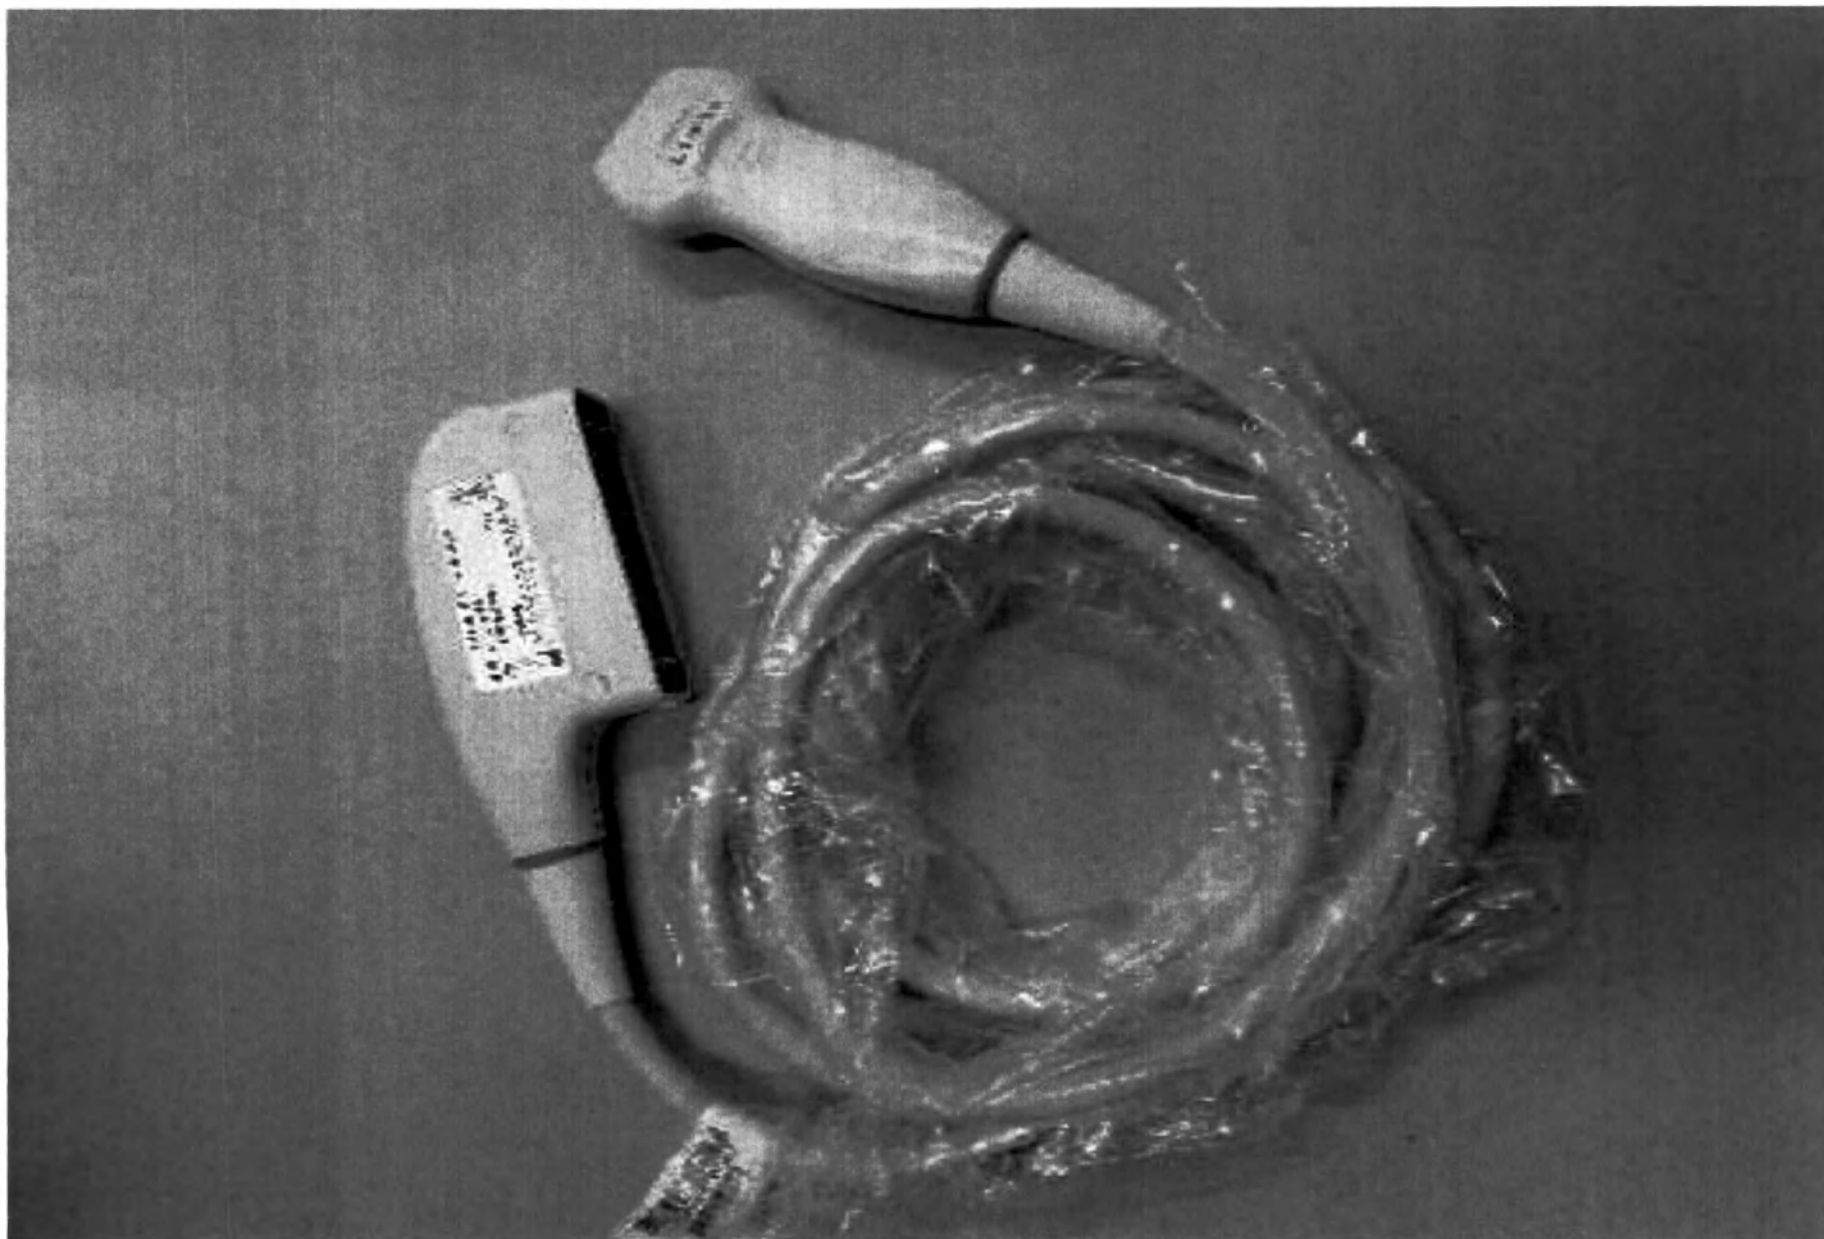


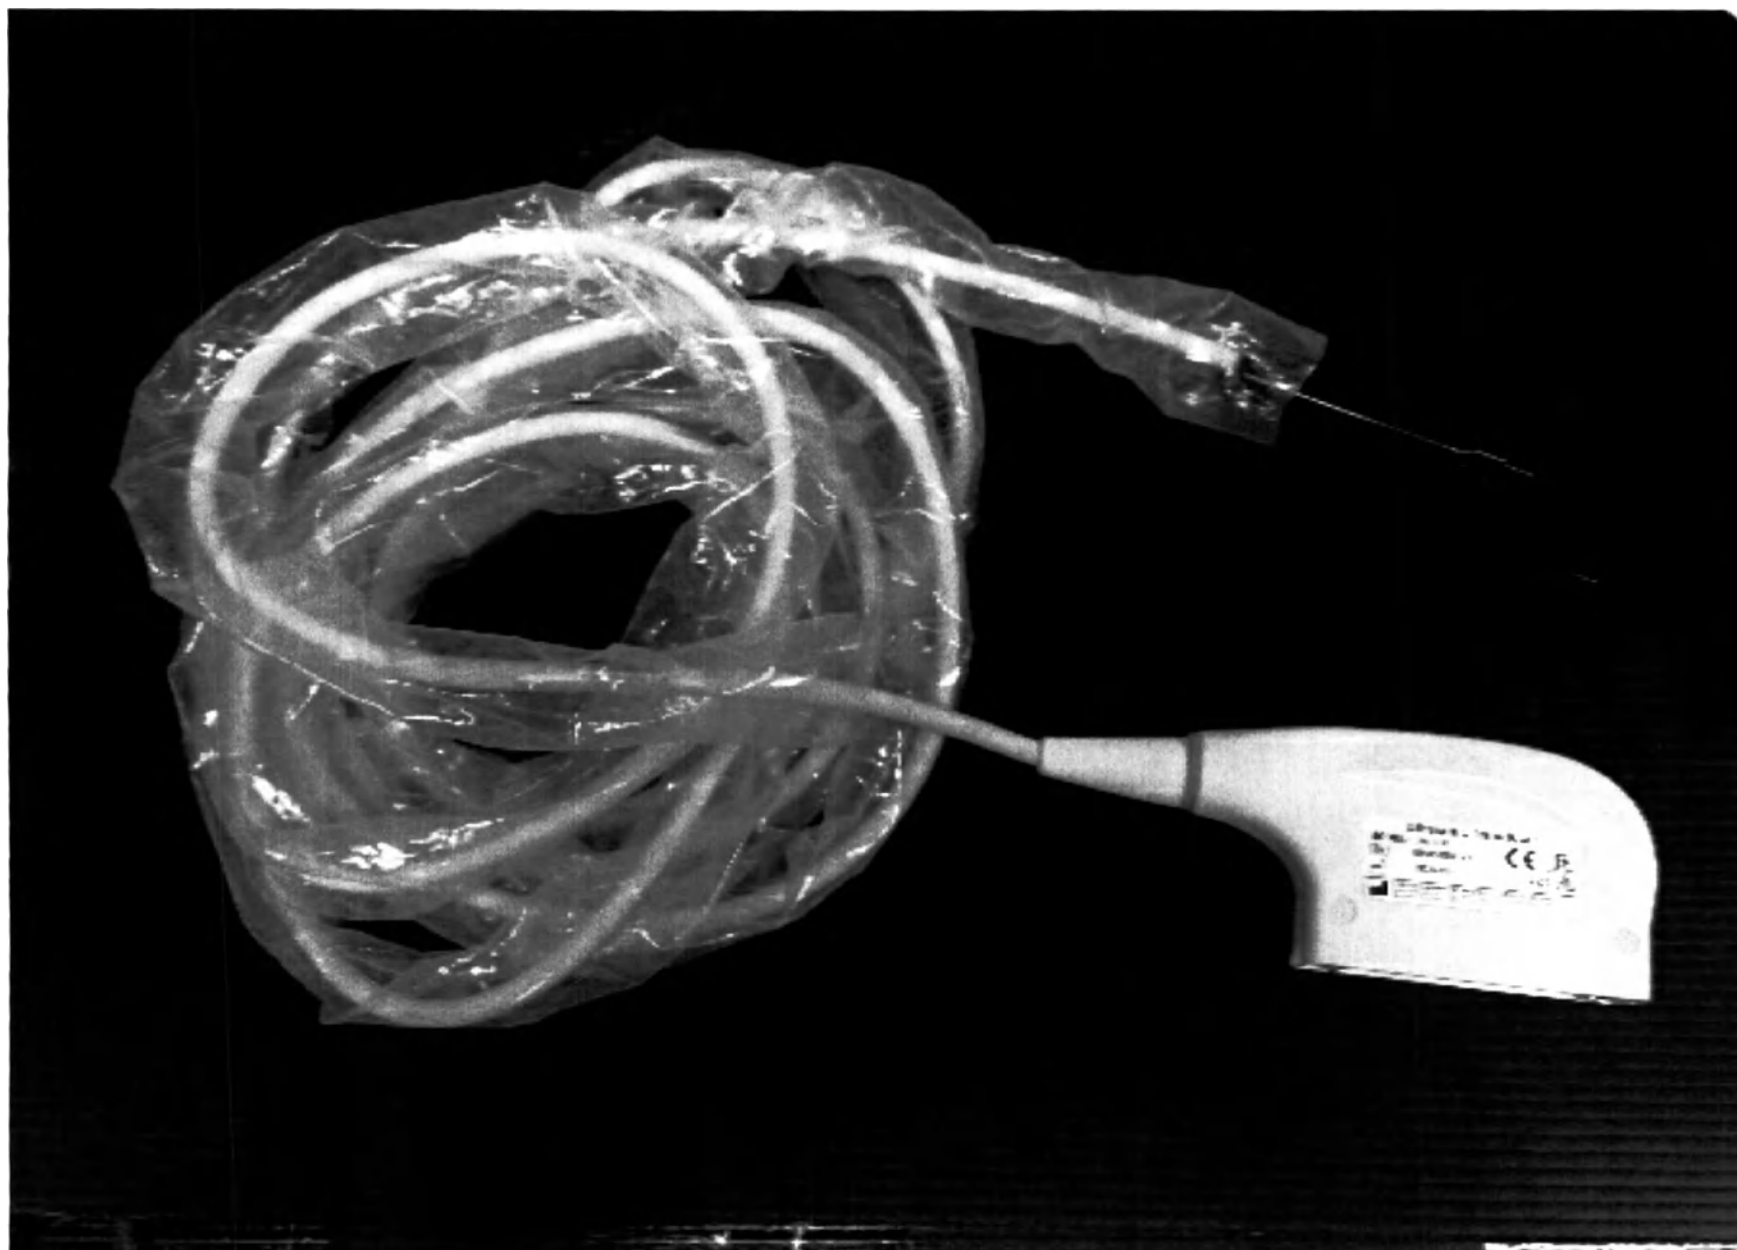


24.17. Датчик ультразвуковой линейный L7-3s

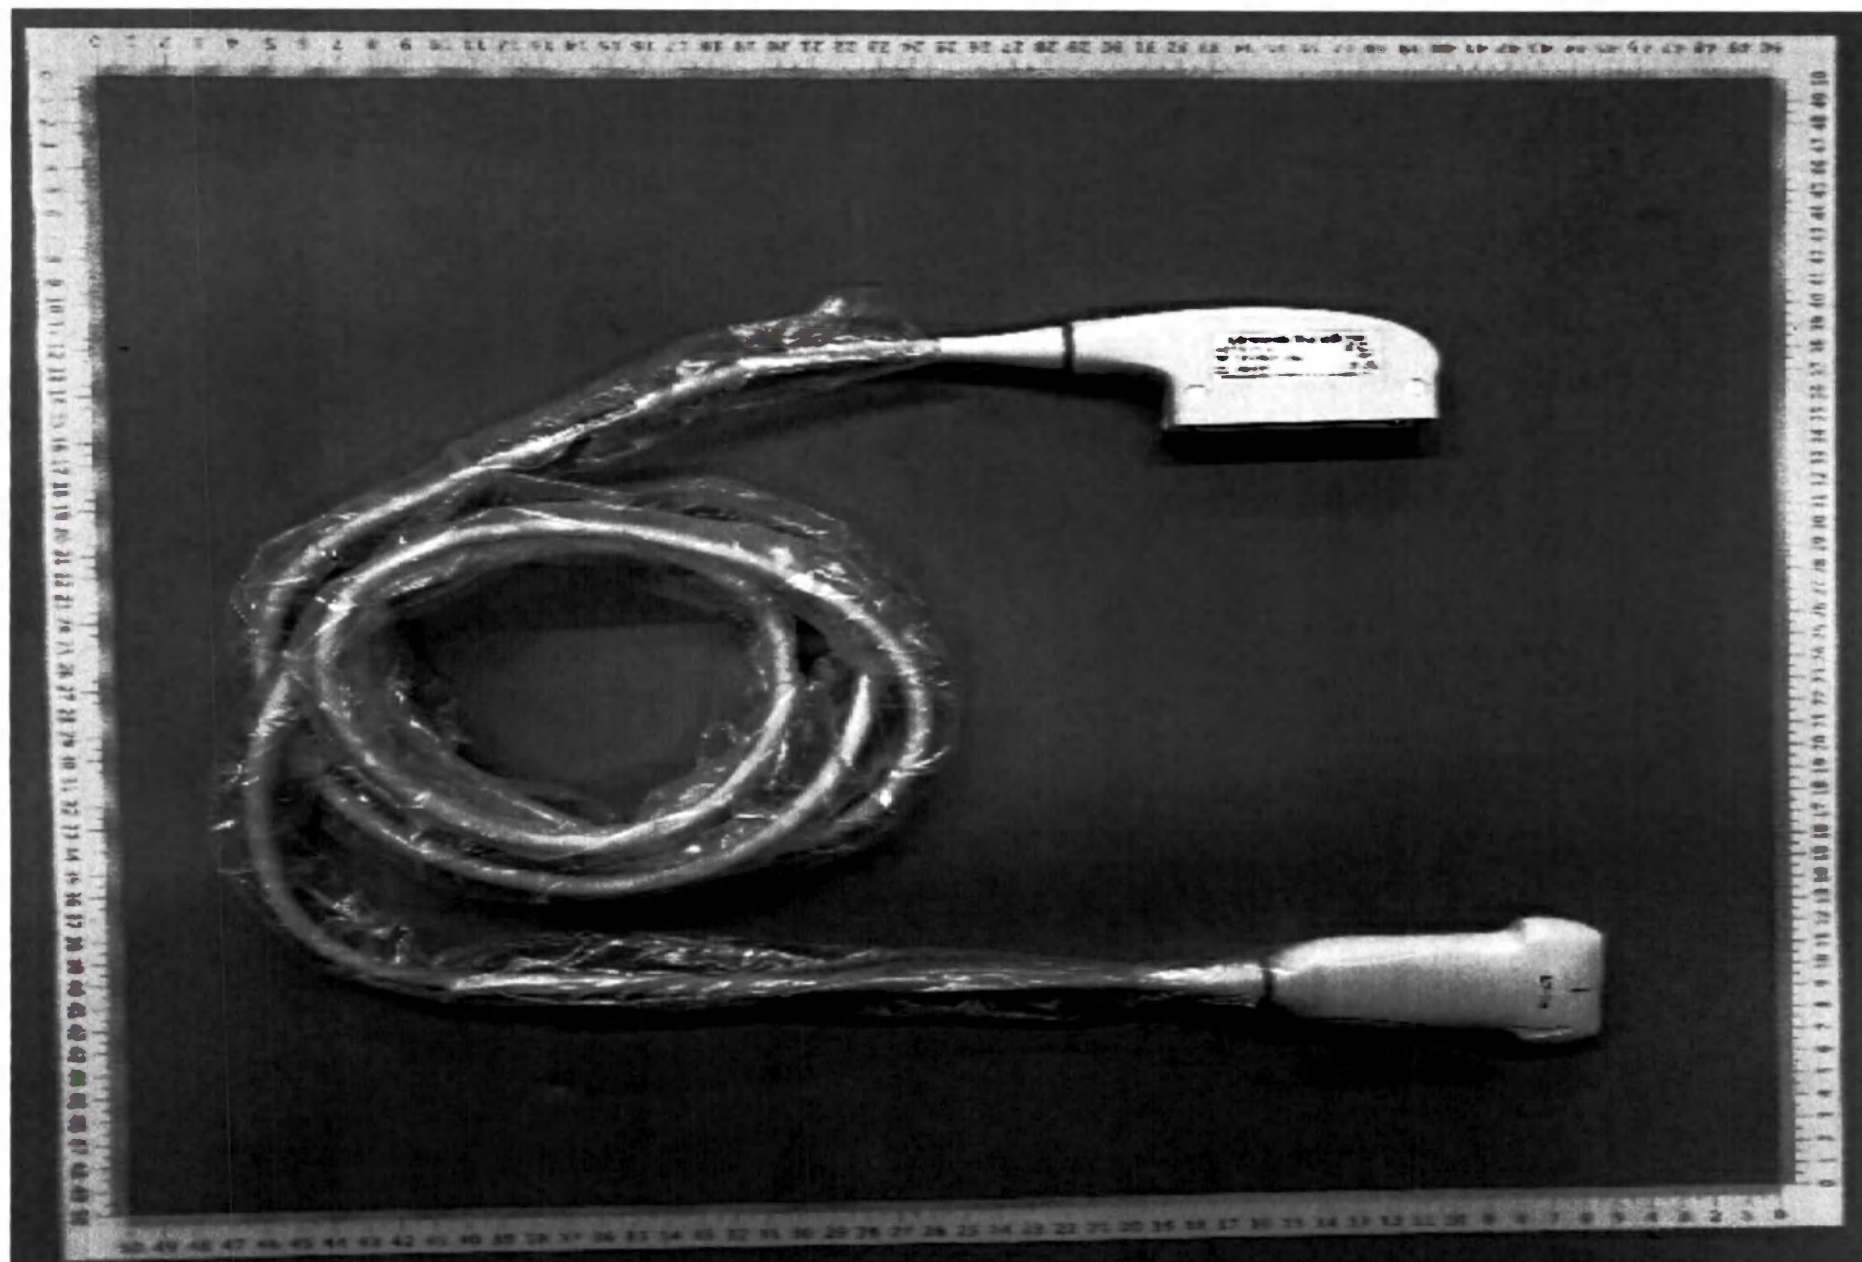




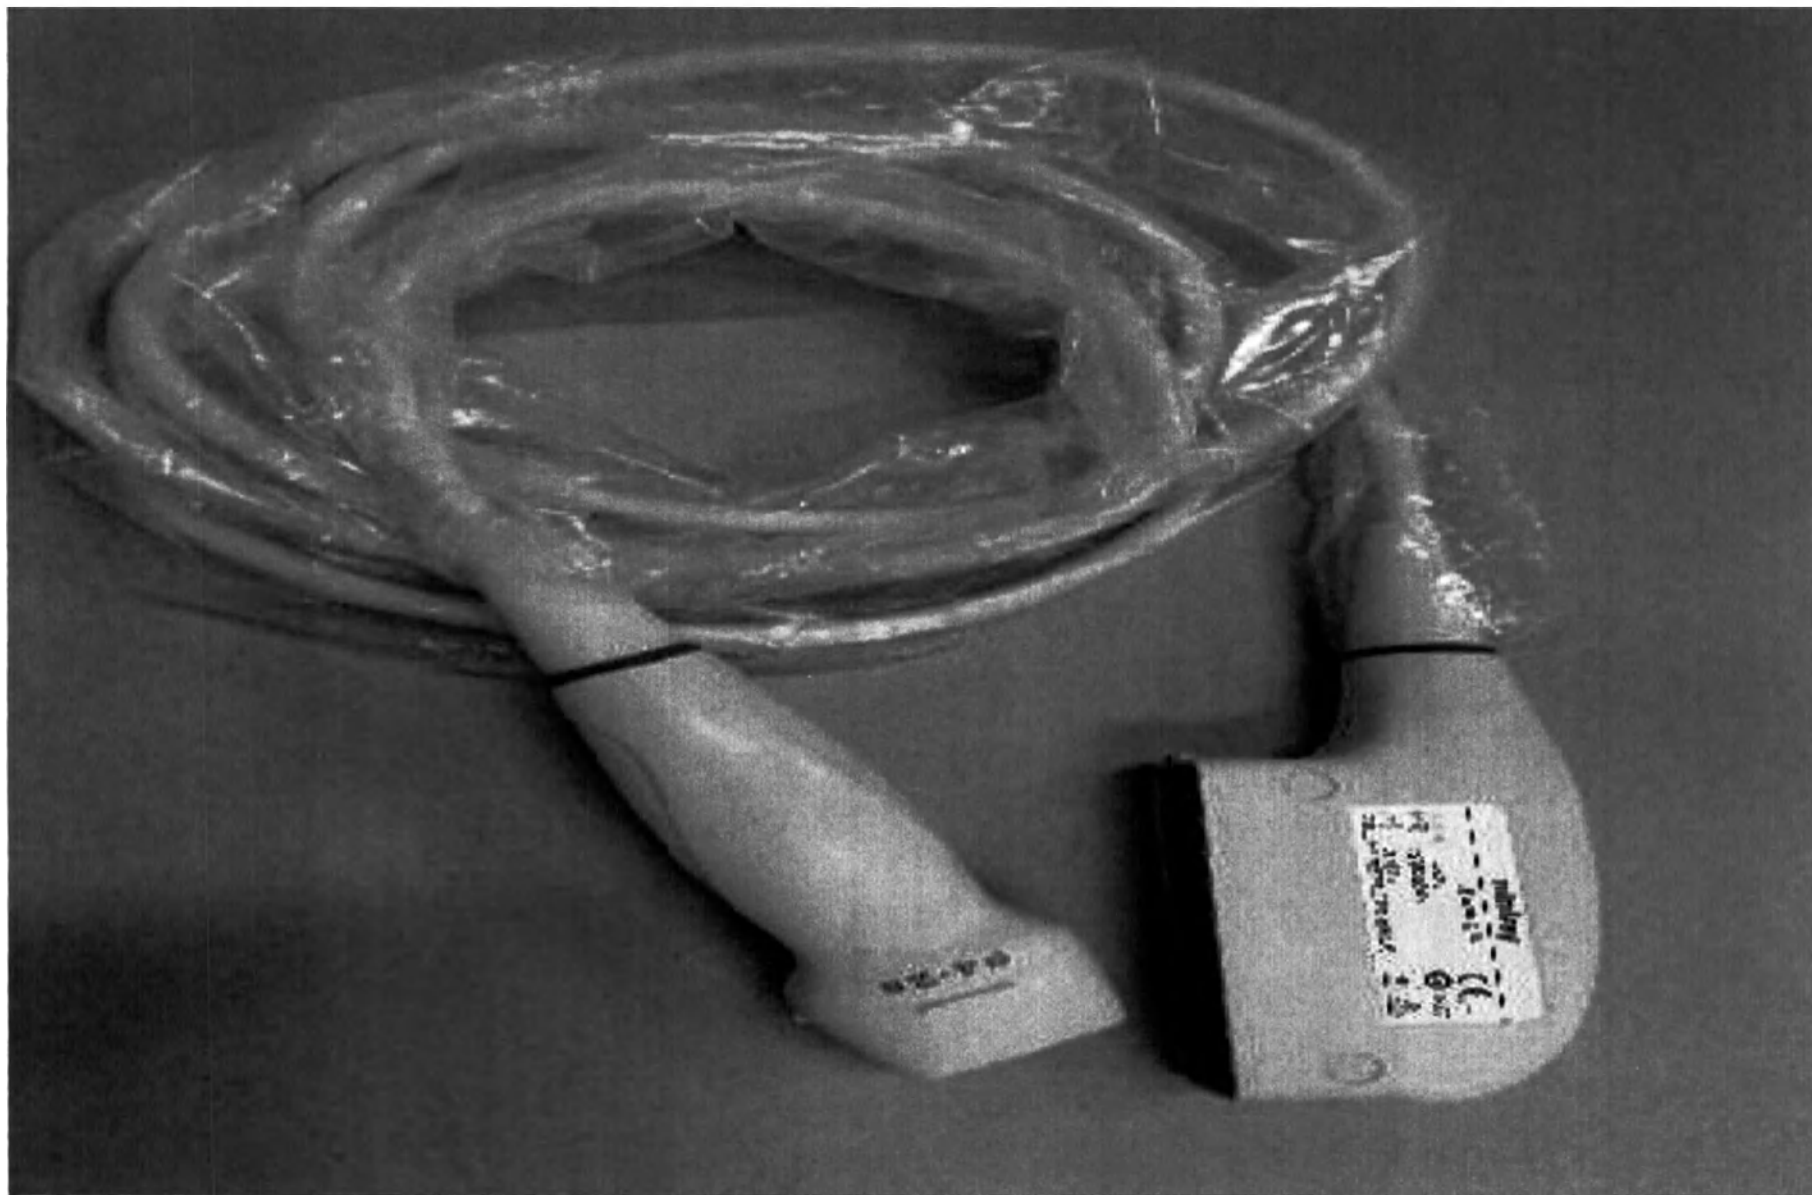

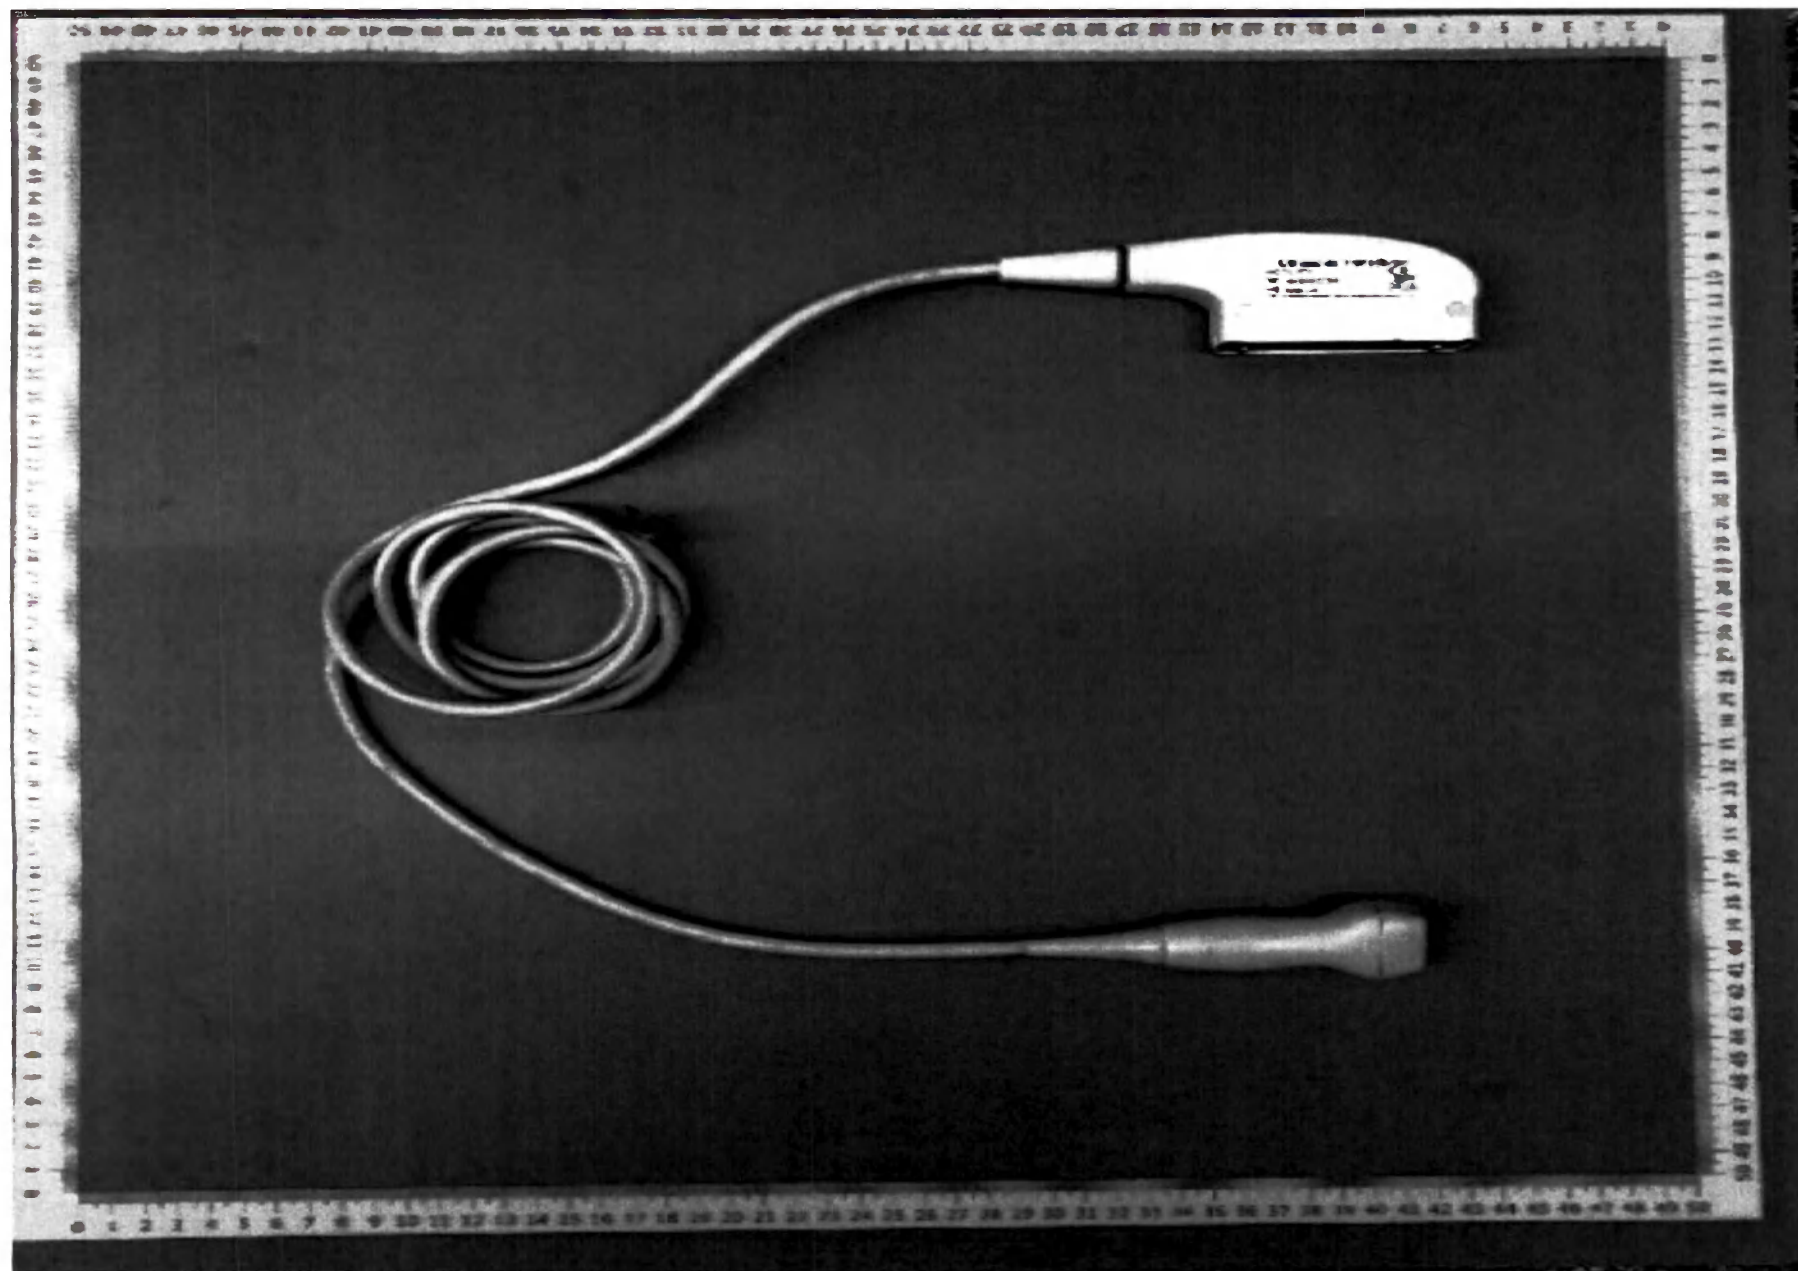


24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный Р7-3Ts в составе:

24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

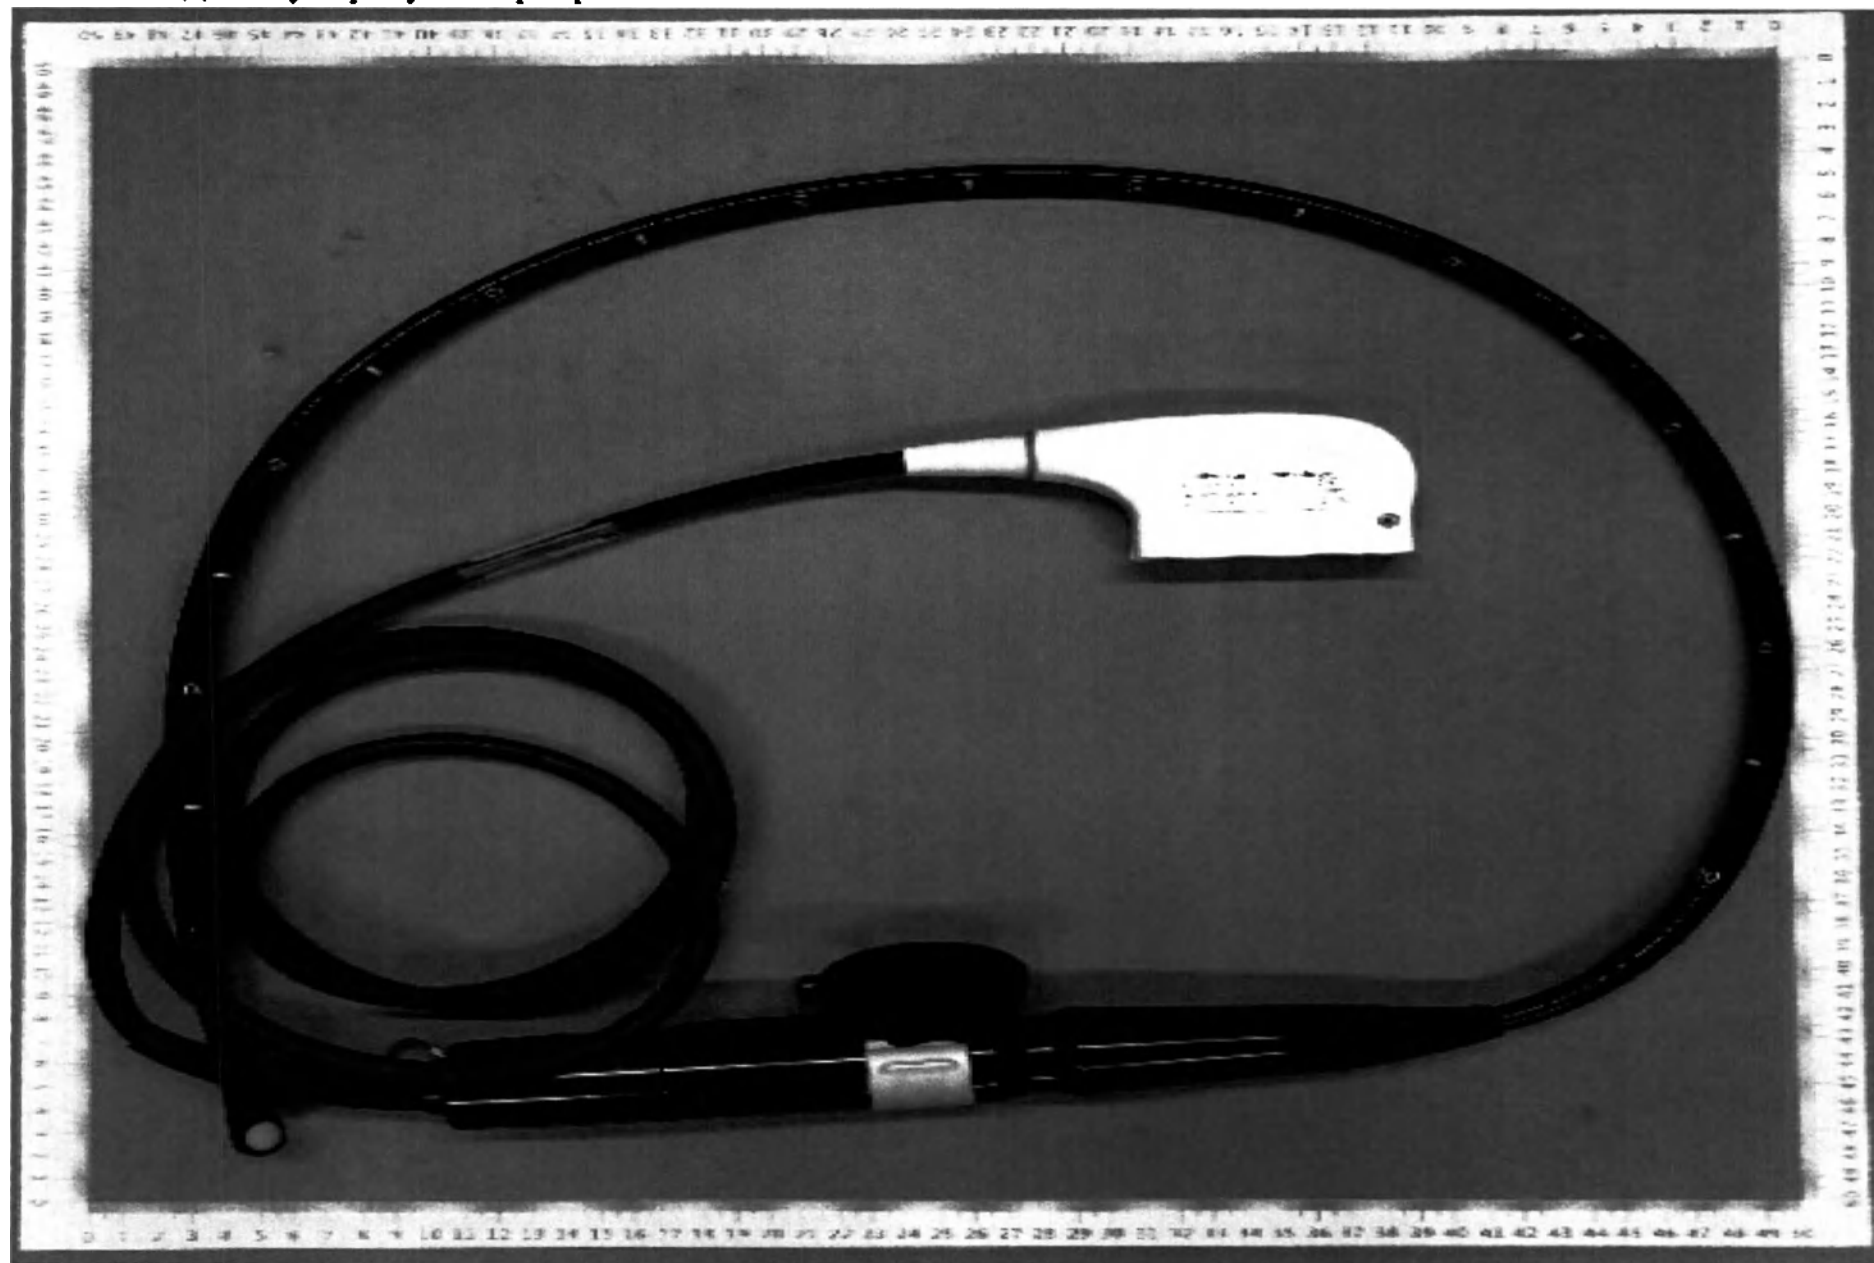




24.22. Датчик ультразвуковой конвексный внутриполостной V10-4Bs

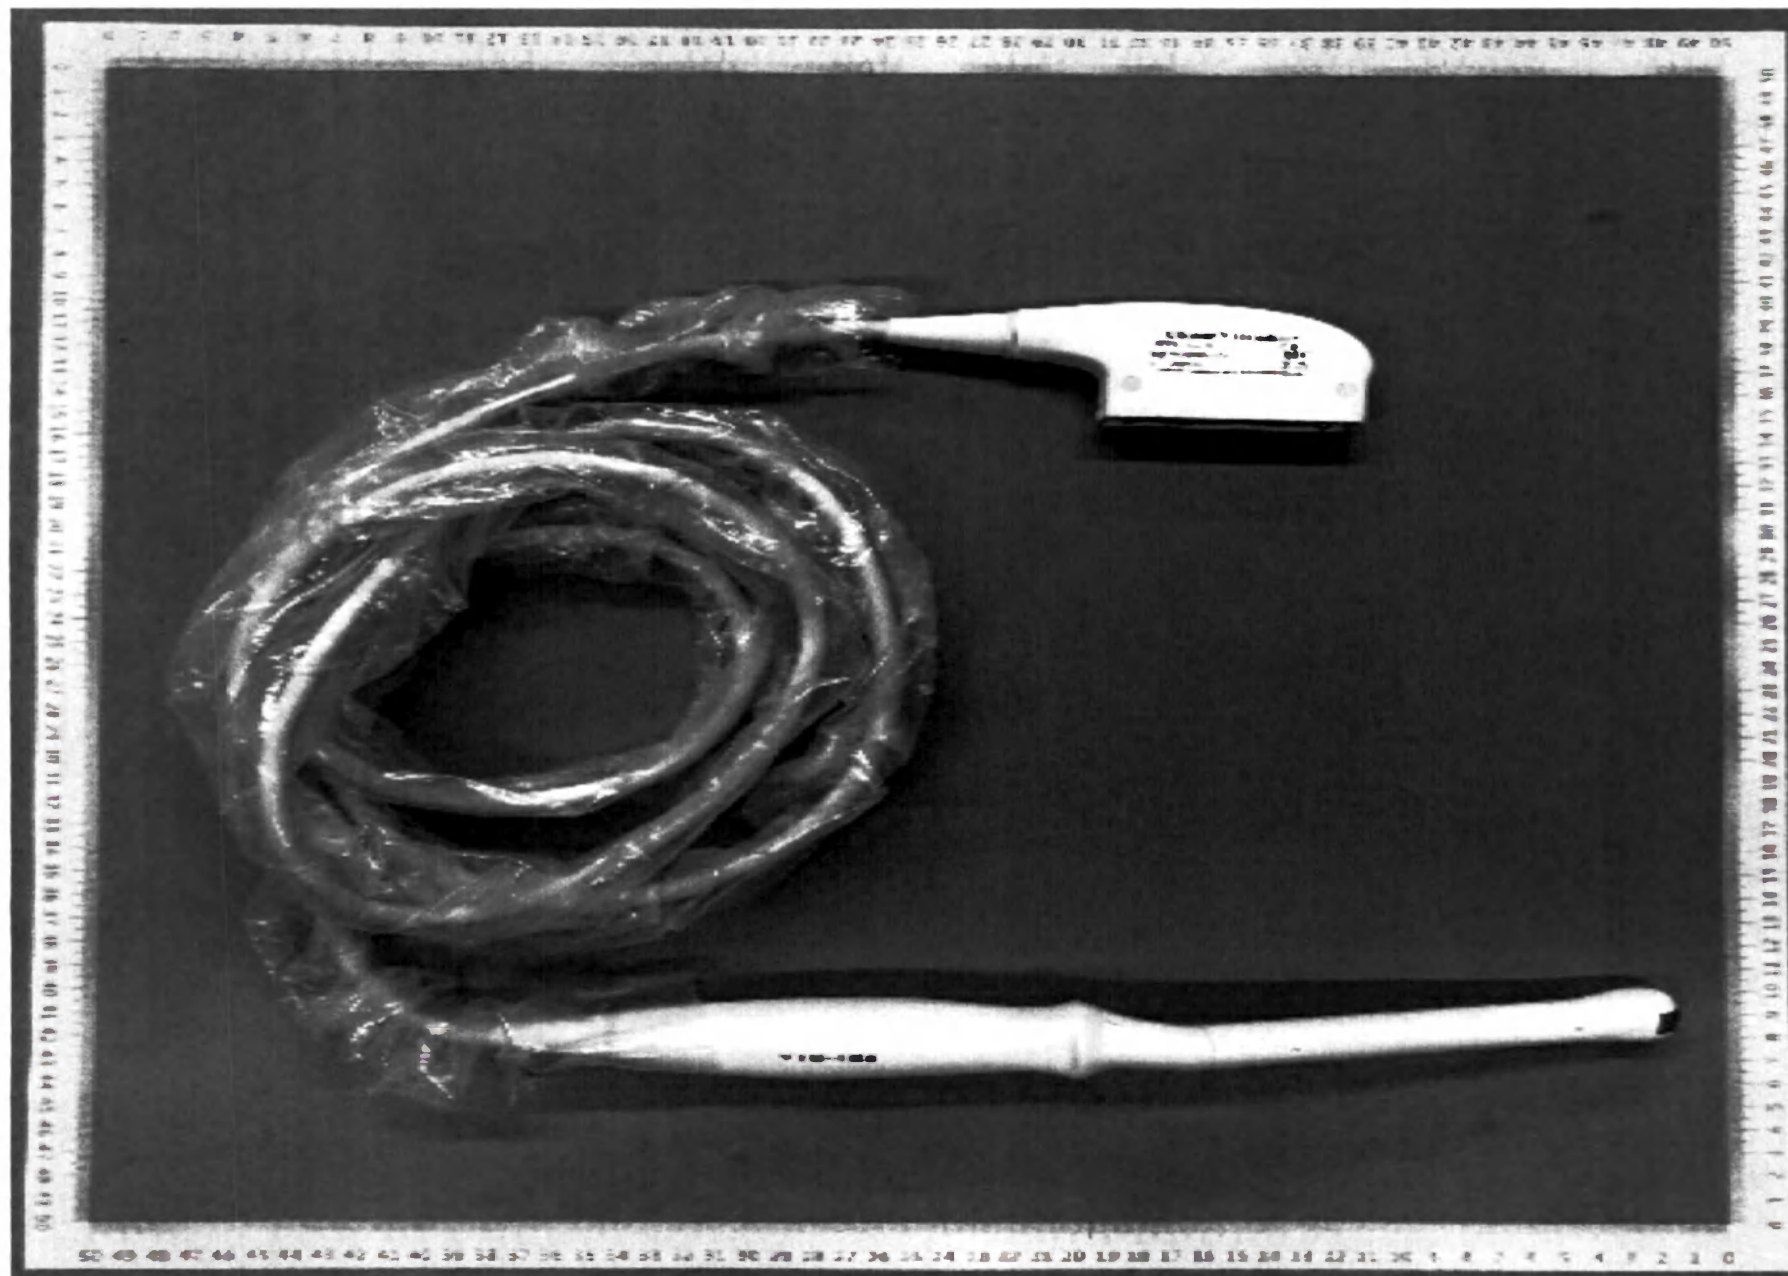


24.23. Датчик ультразвуковой конвексный внутриполостной V10-4s

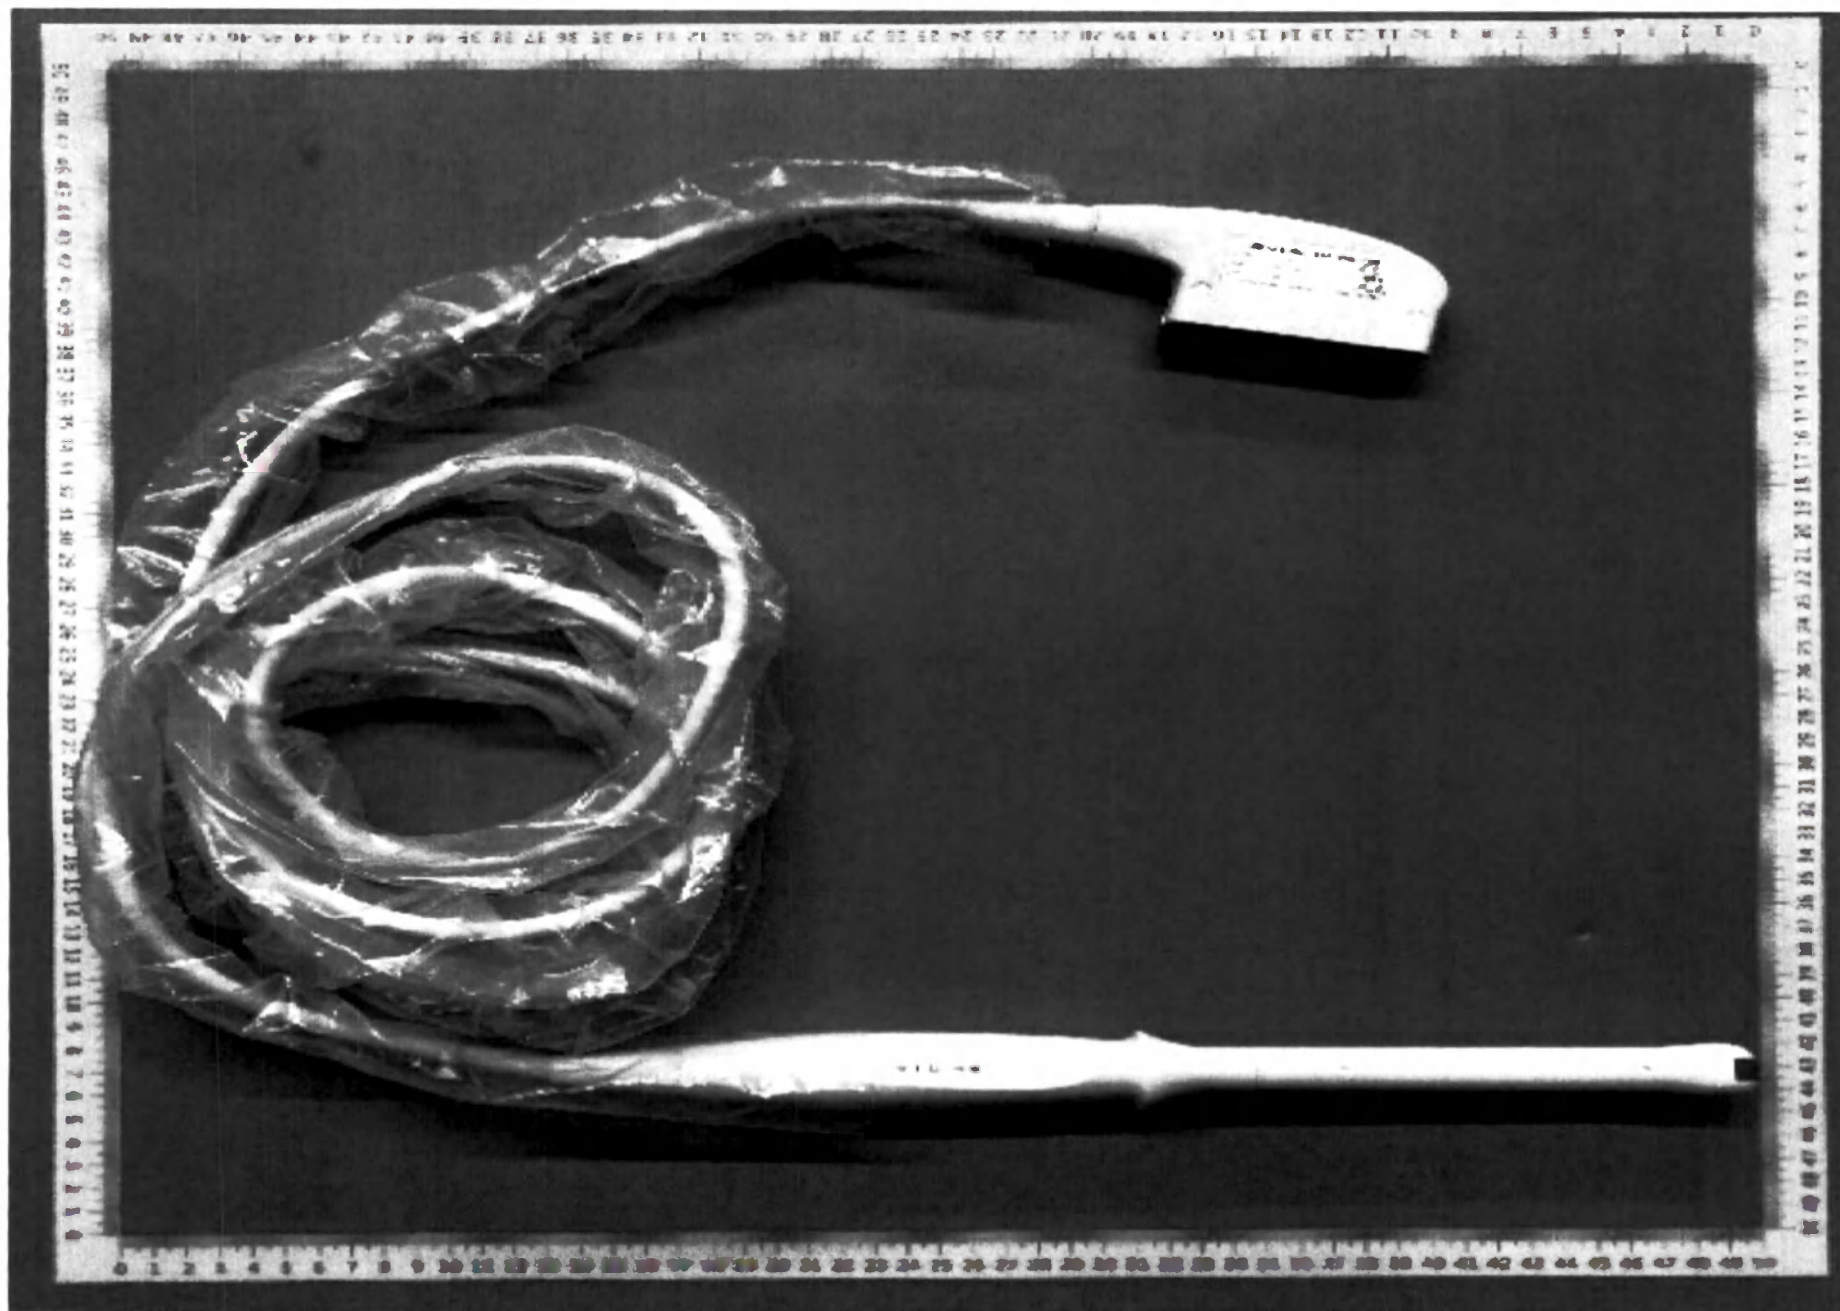


25. Насадки биопсийные, варианты исполнения

25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

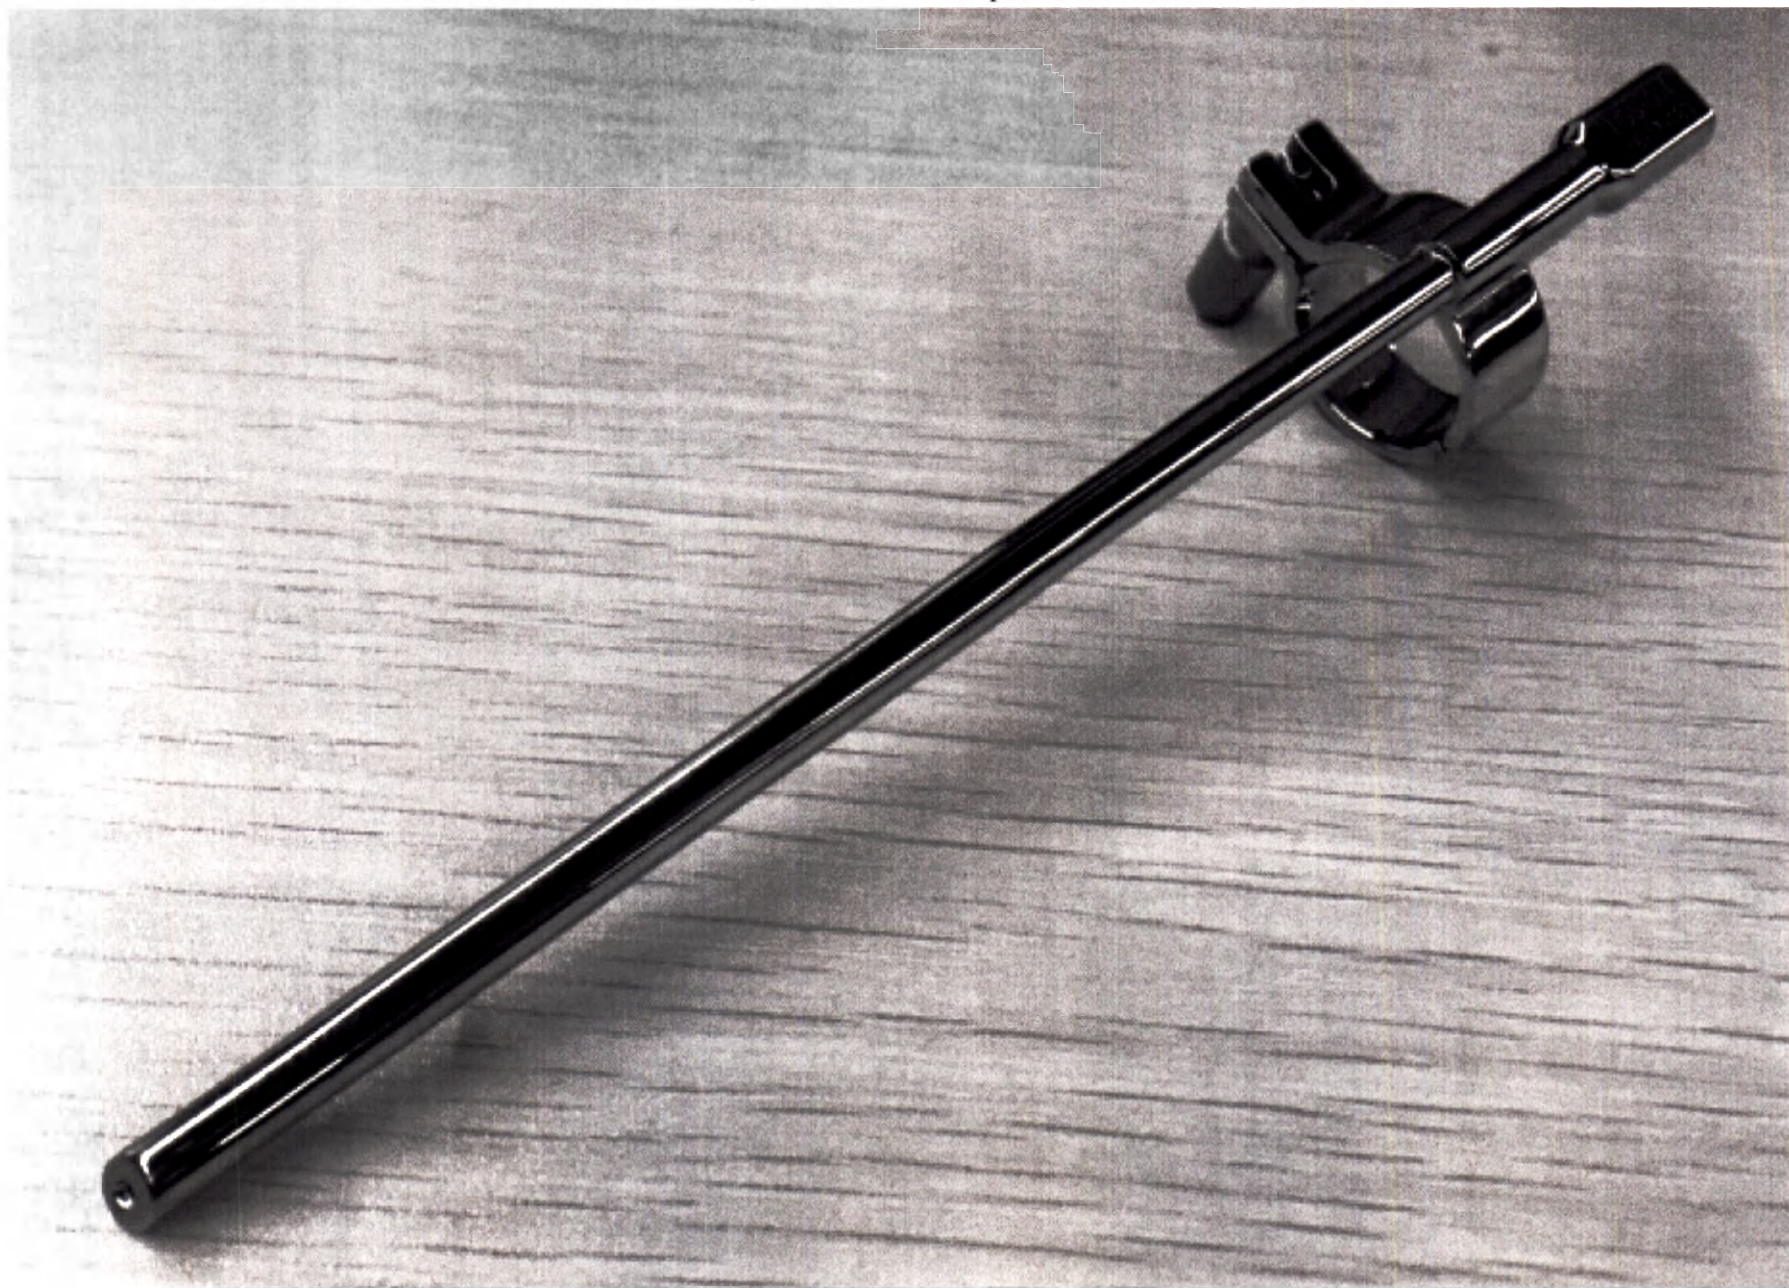



25.2. гисадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-005

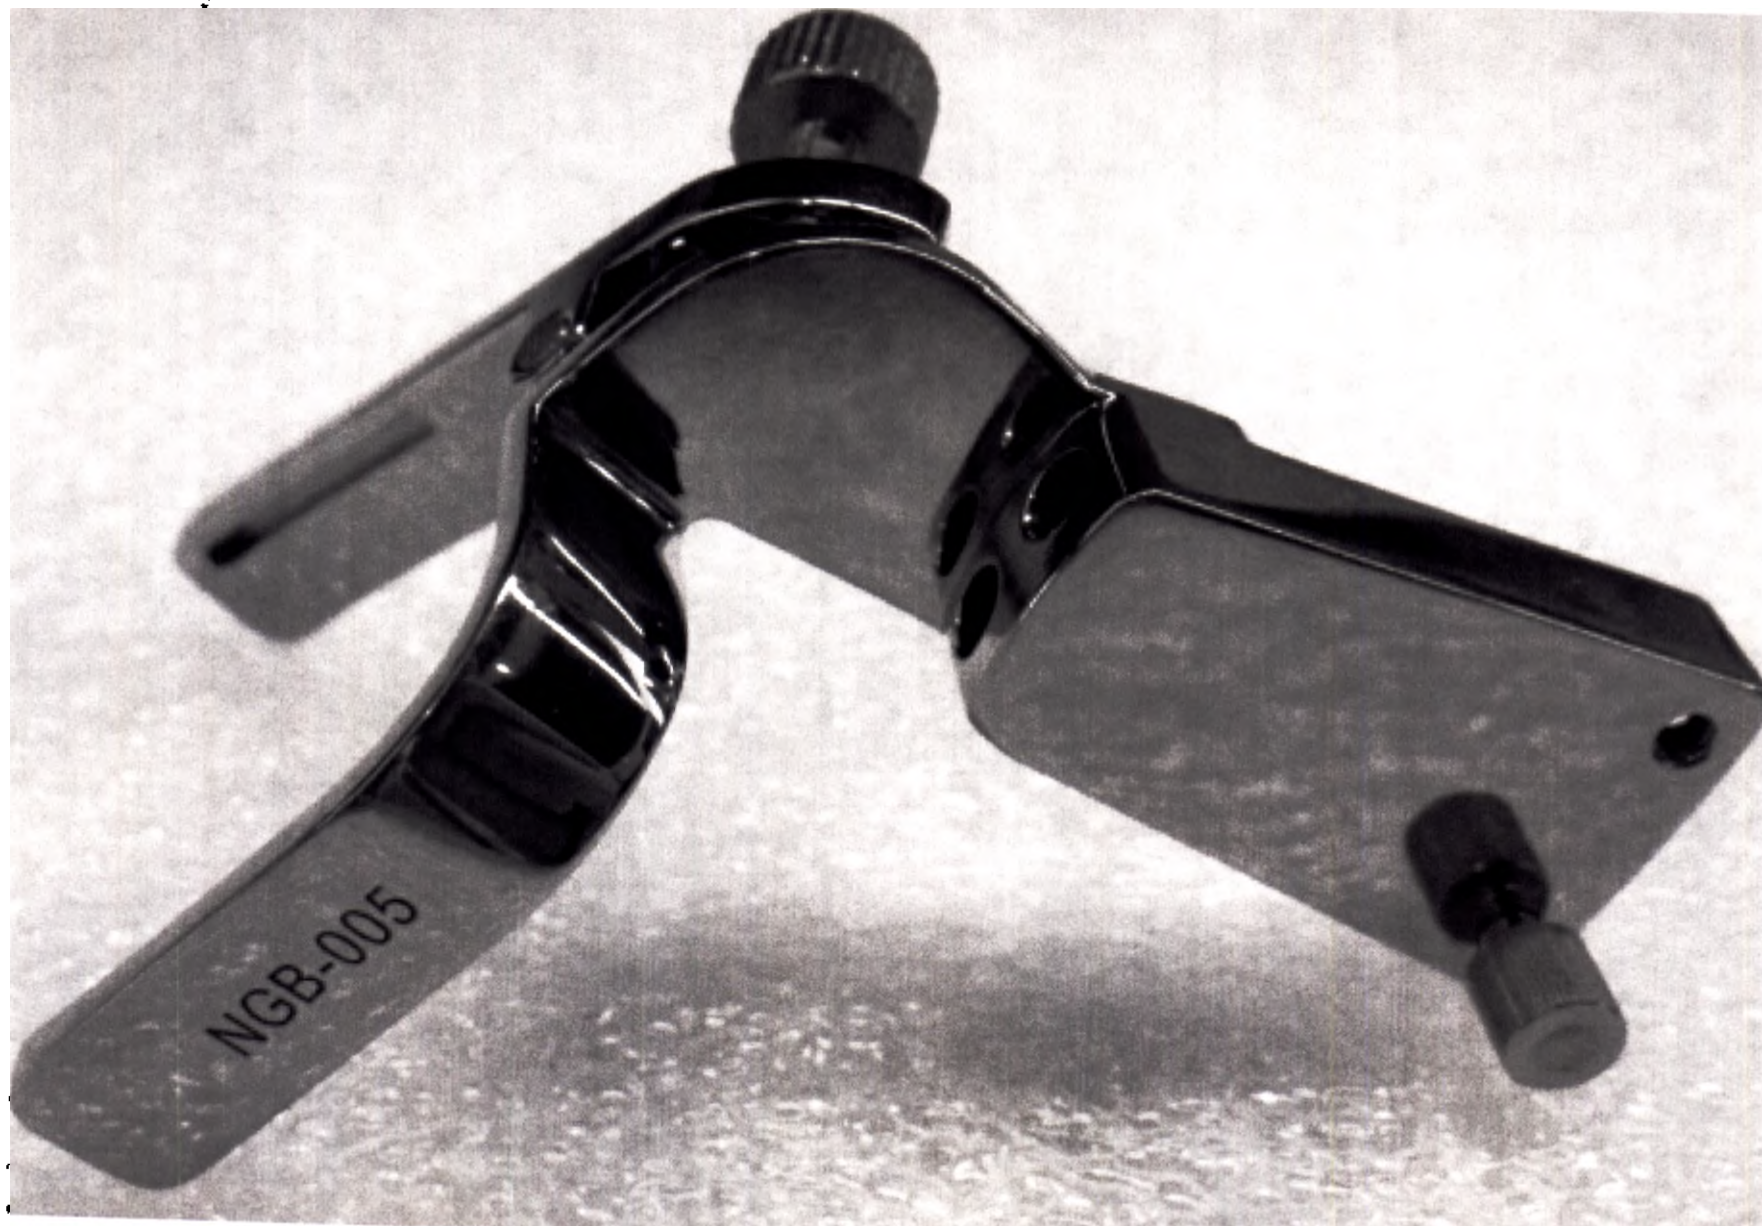





25.4. Насадка биопсийная пластиковая, со съемной направляющей для игл NGB-006

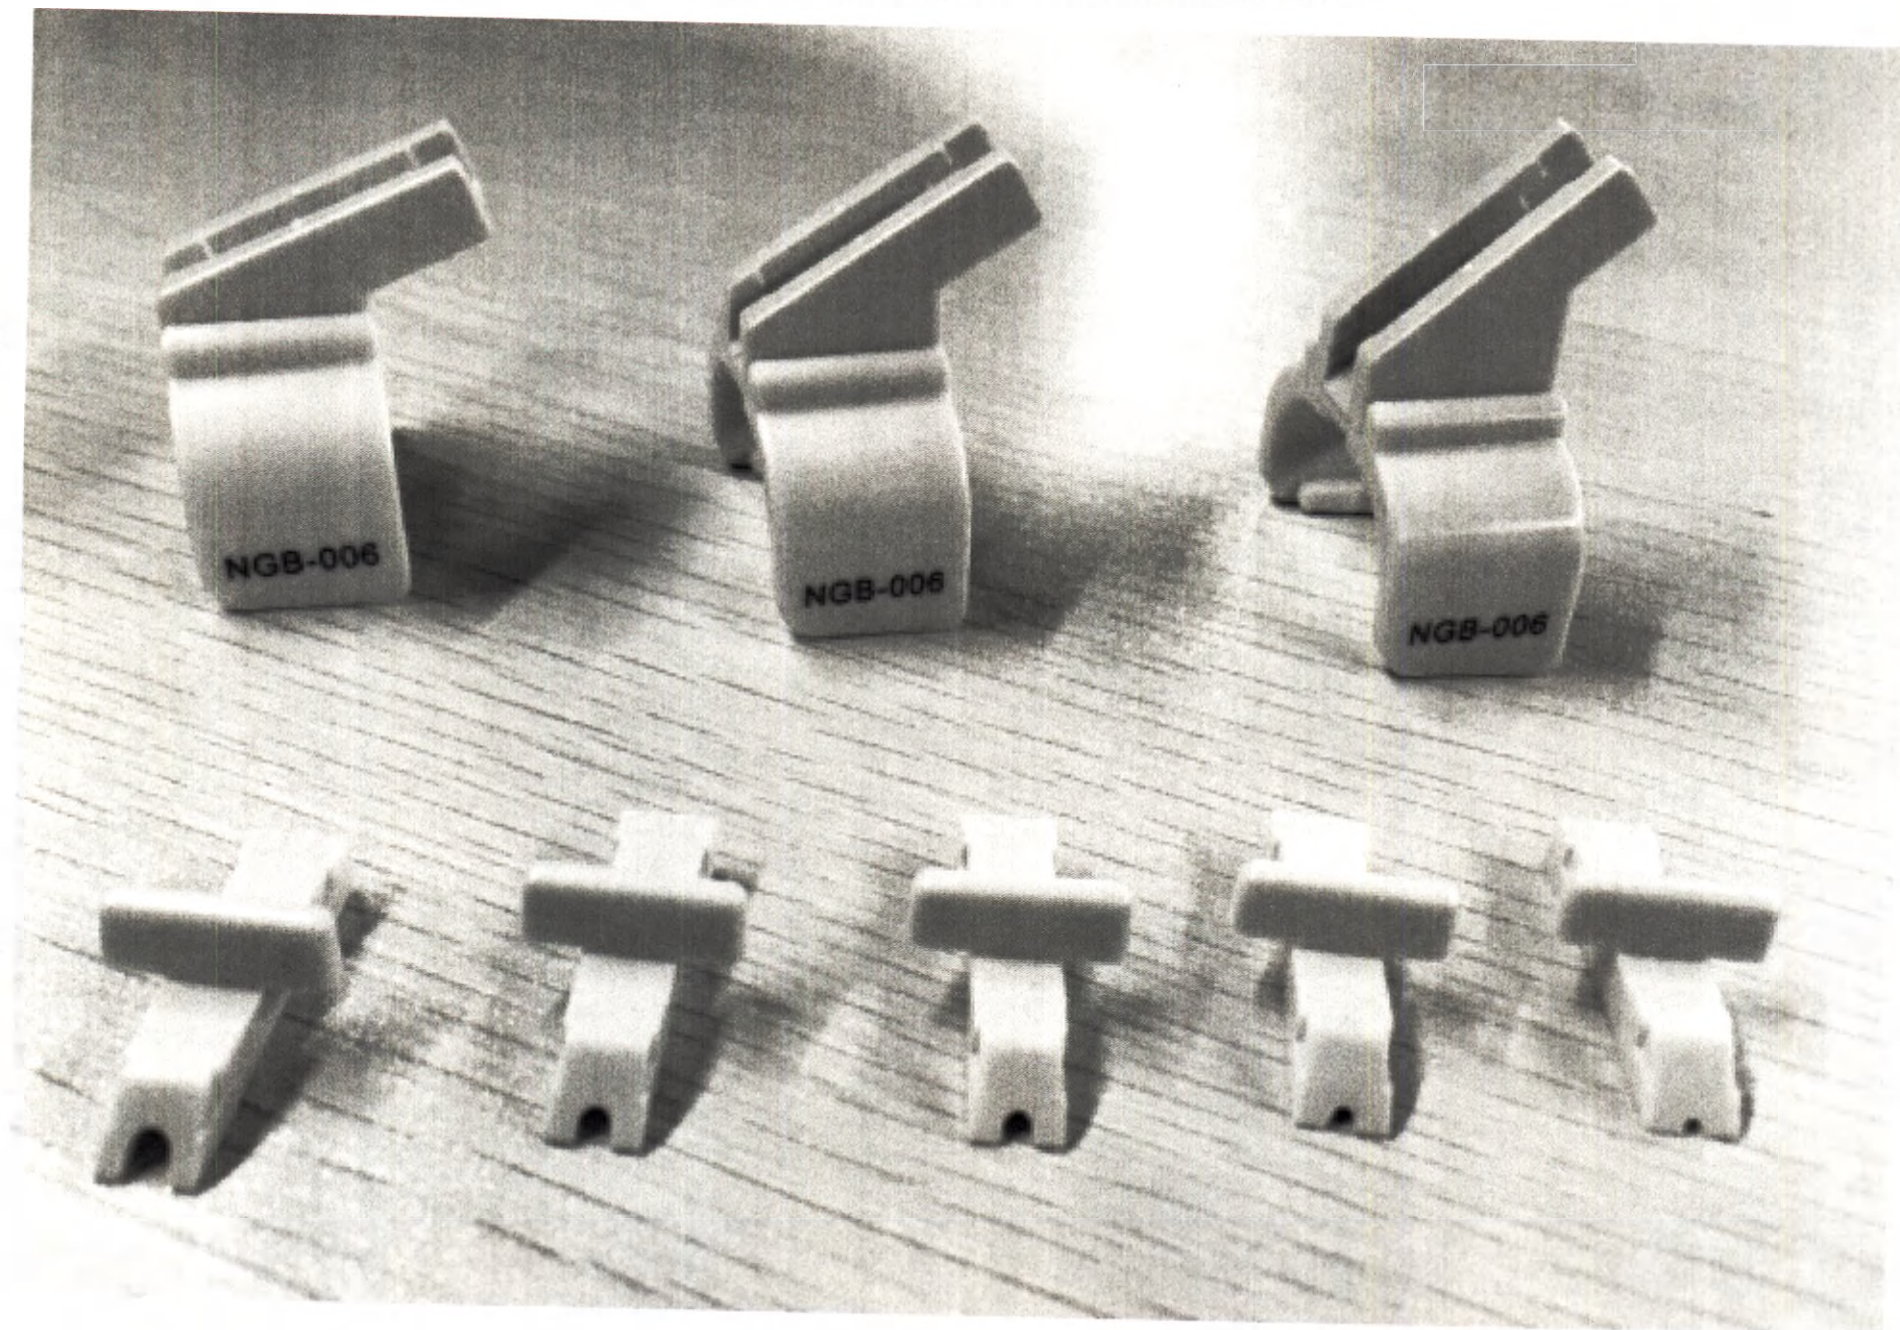


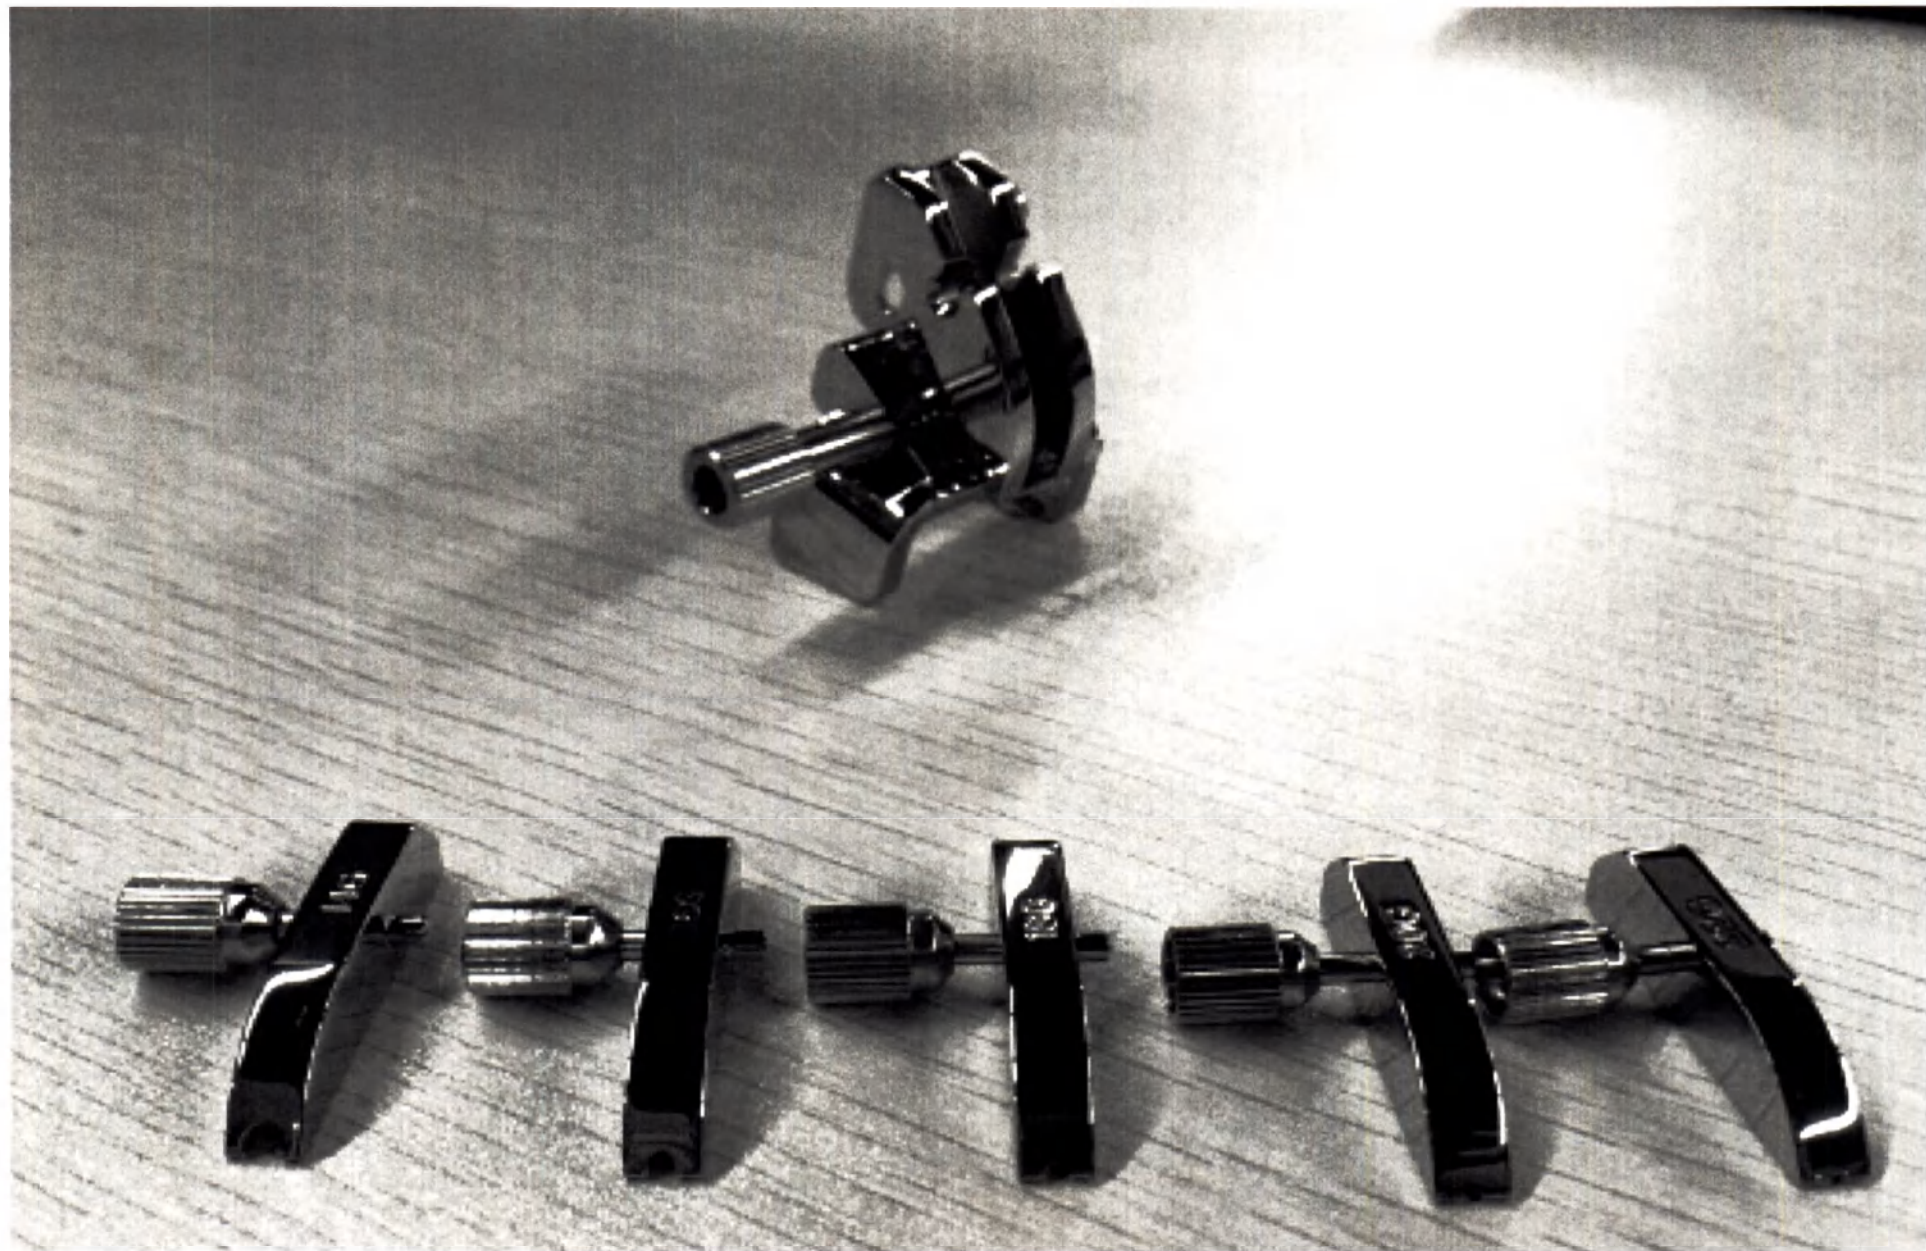


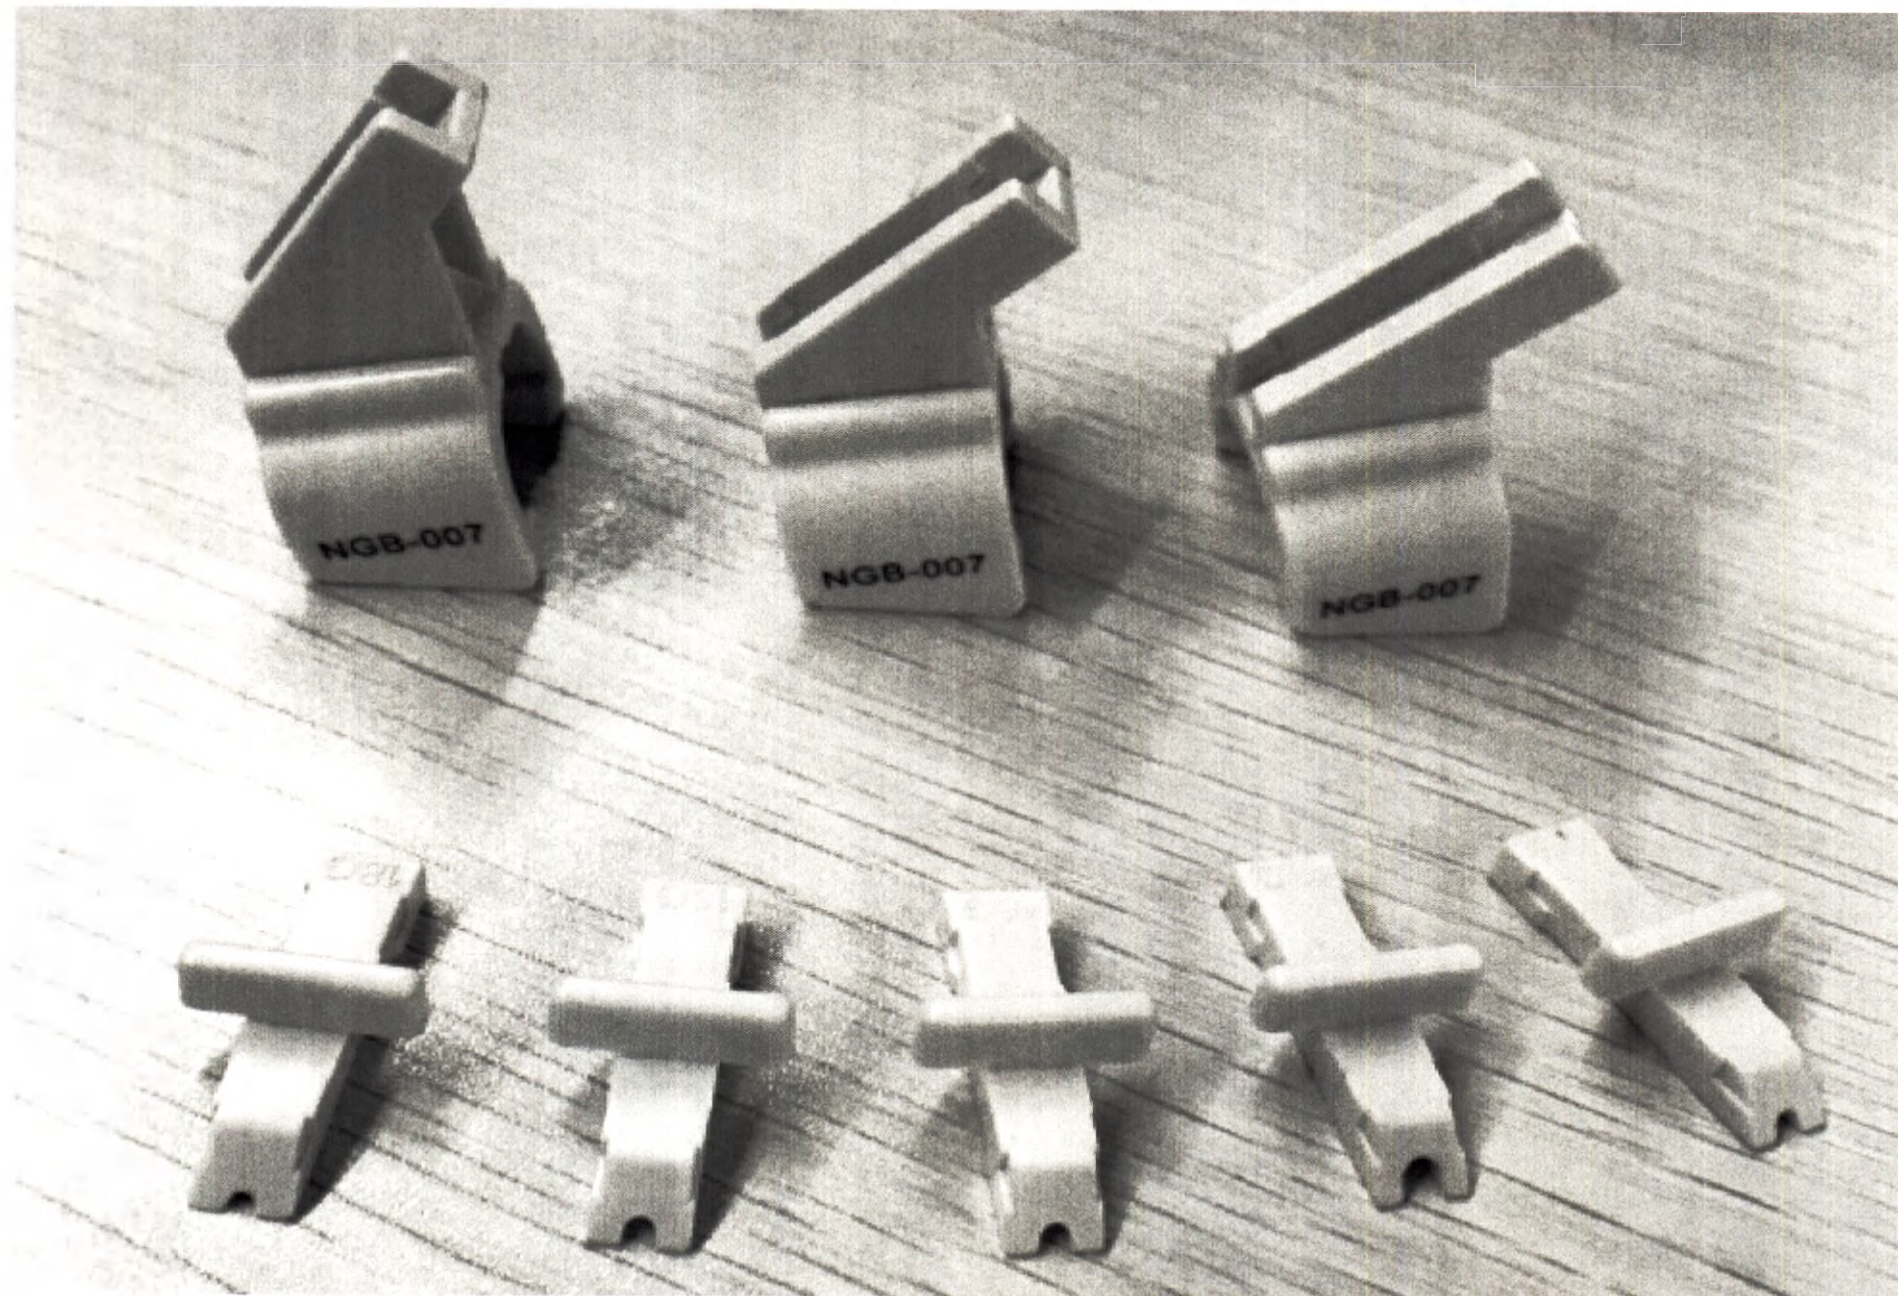

25.7. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-009

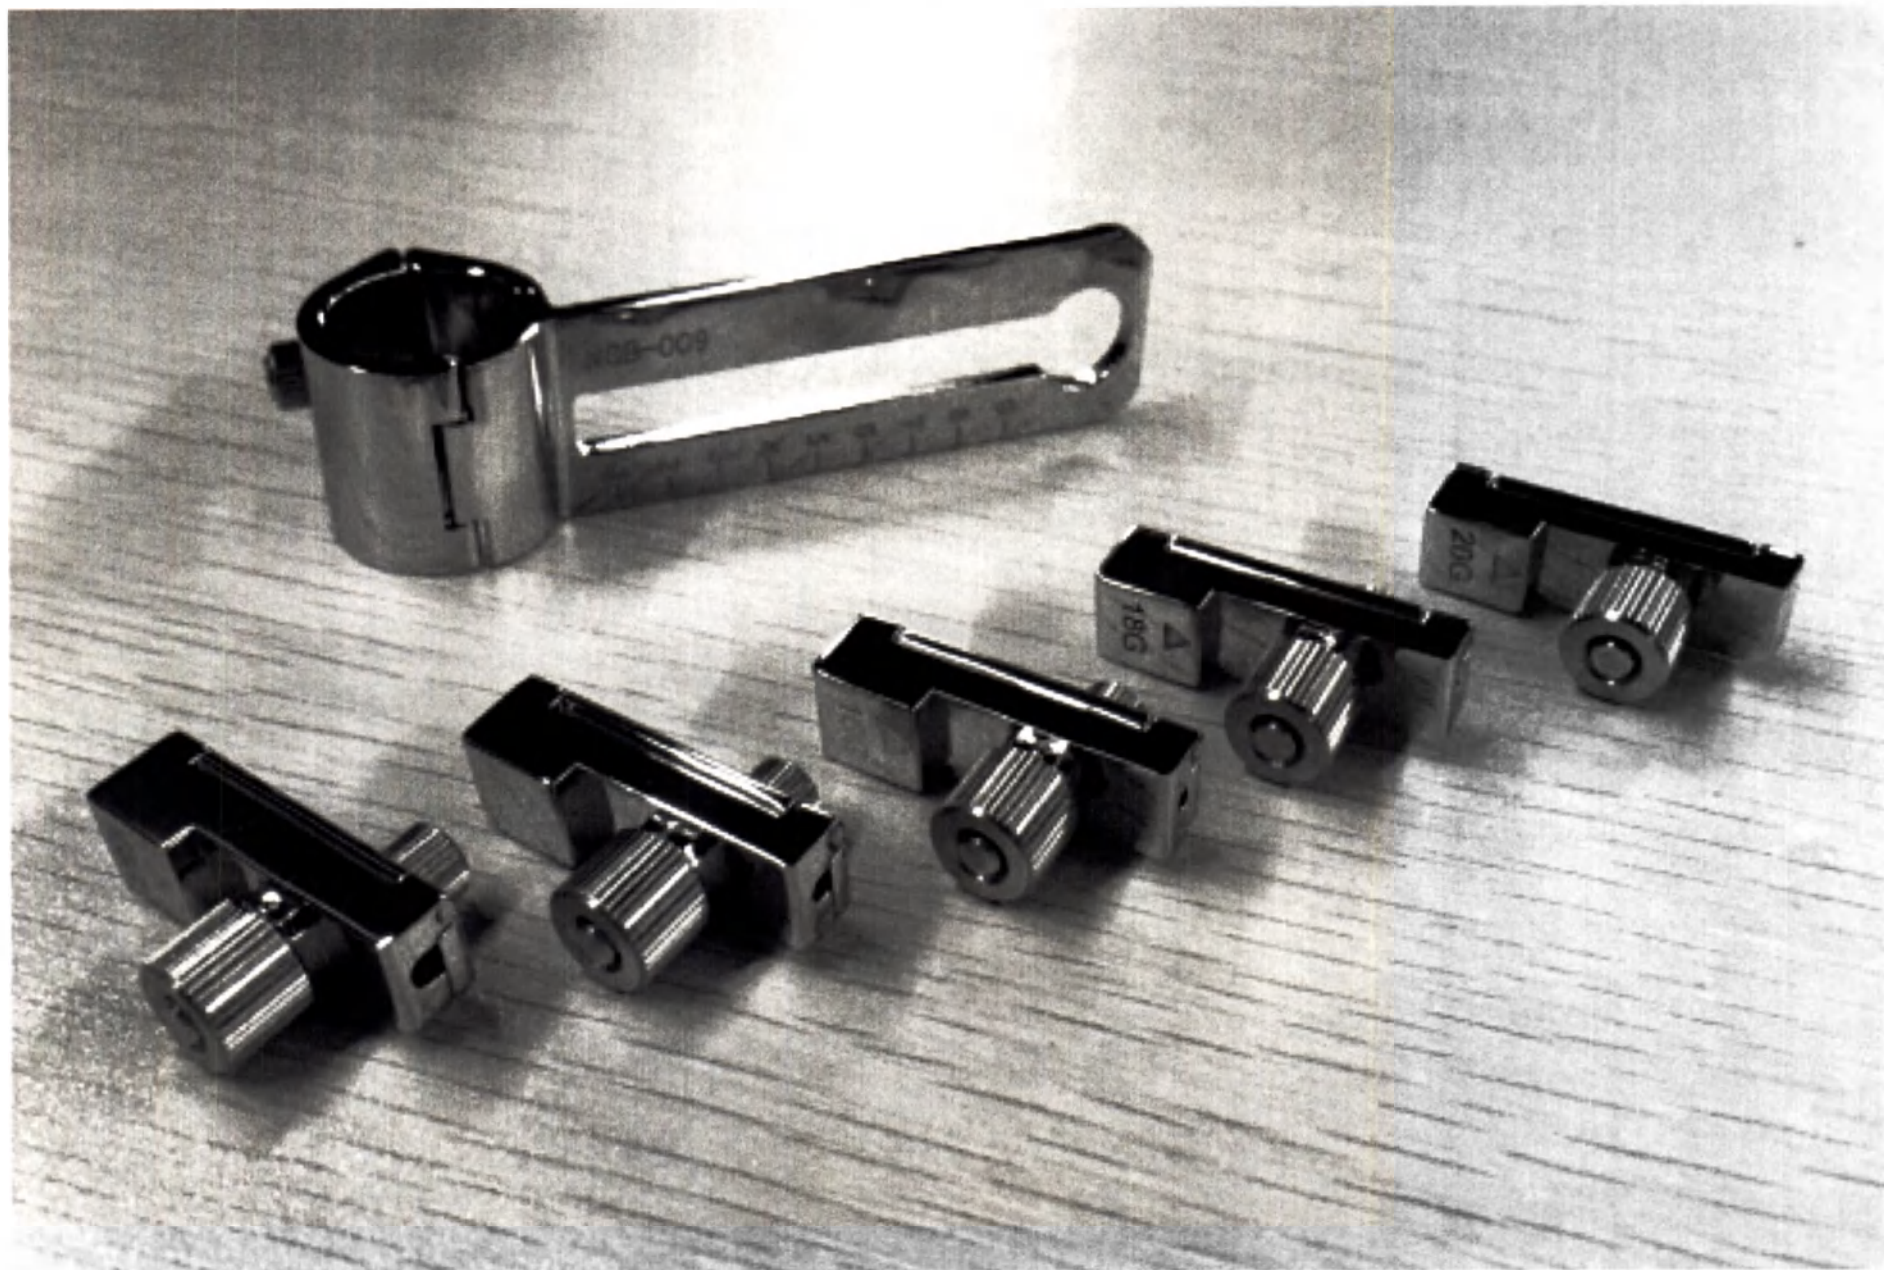

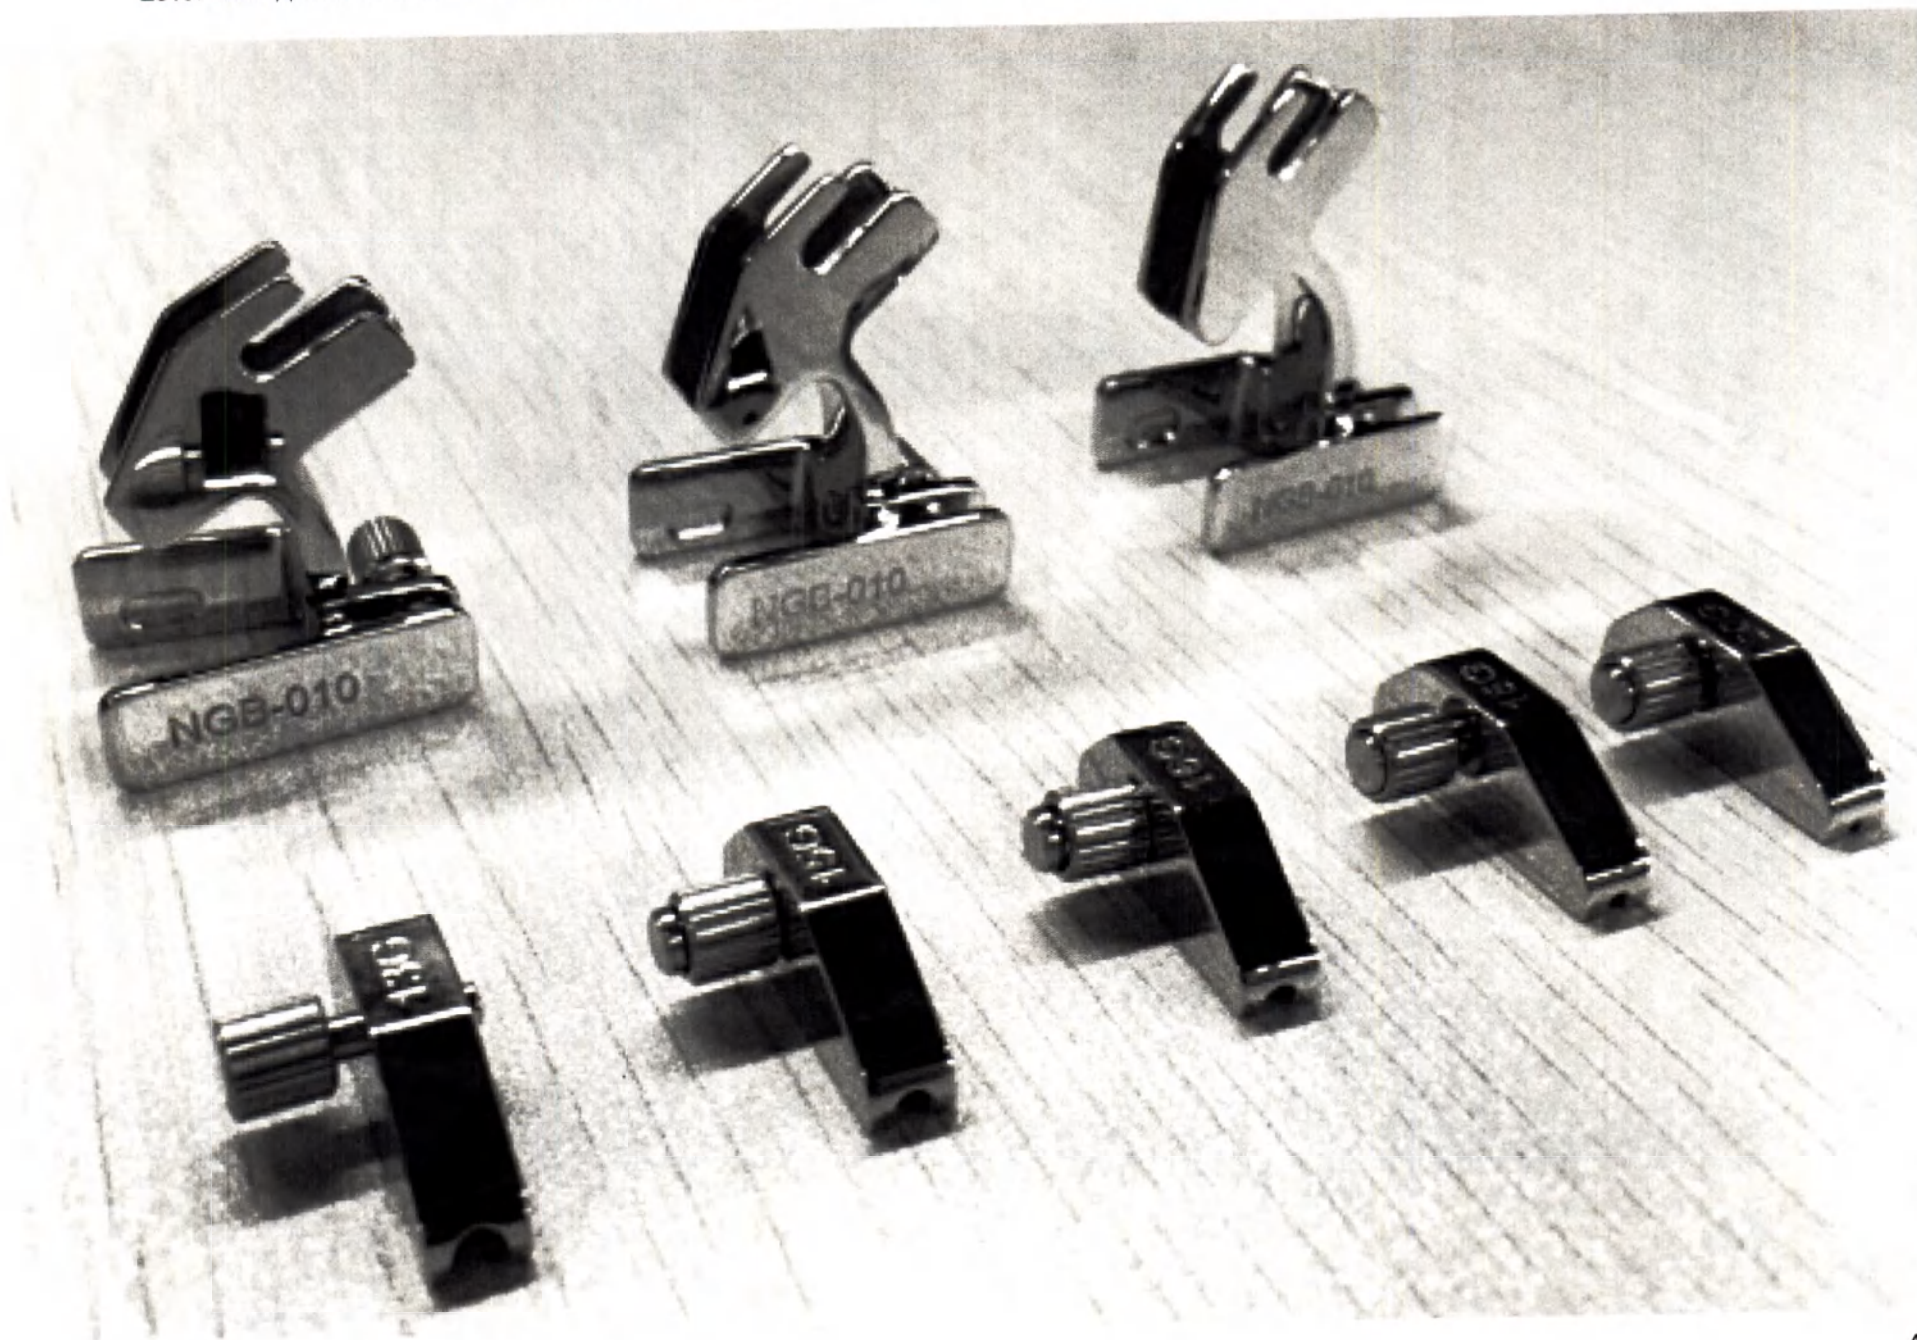

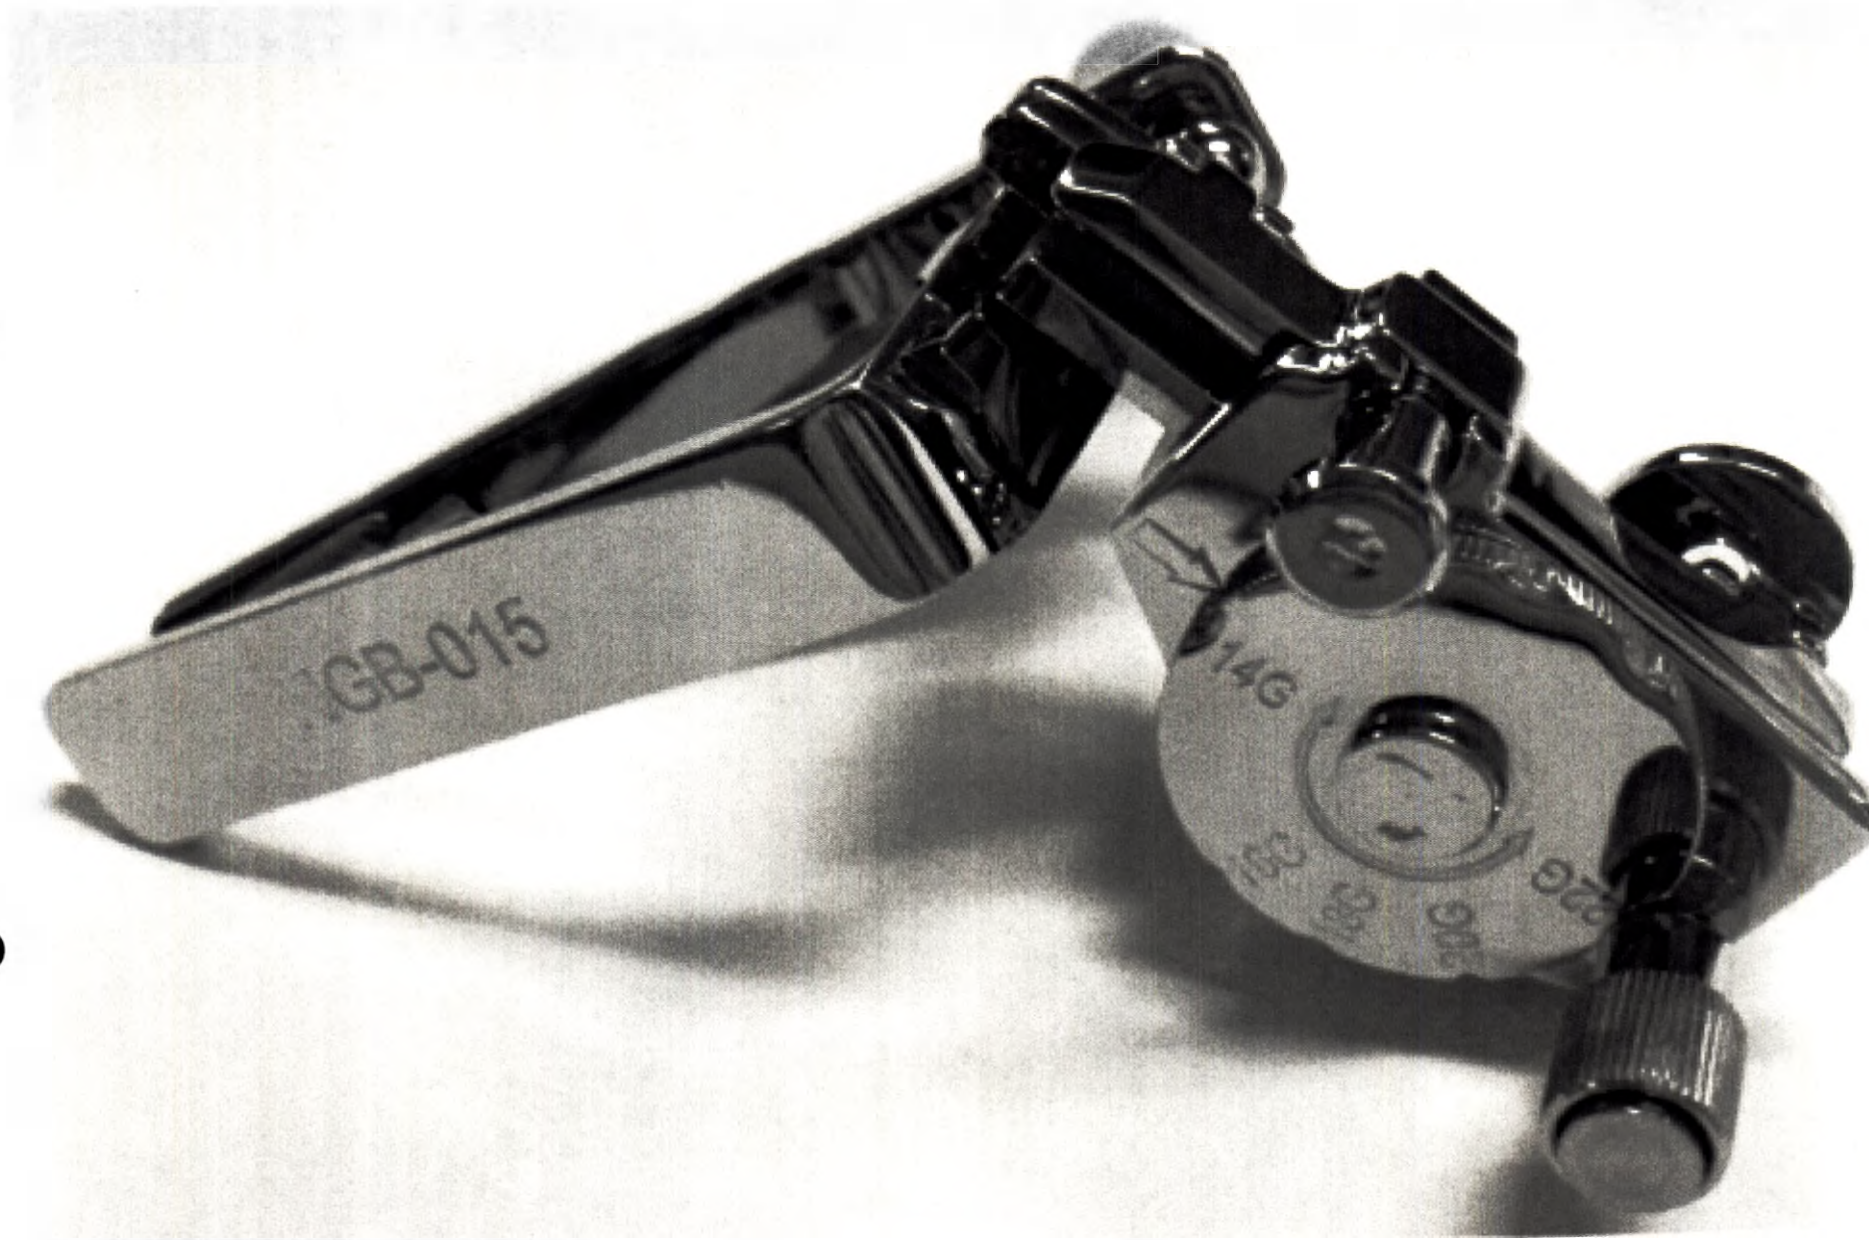




25.11. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018



26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)

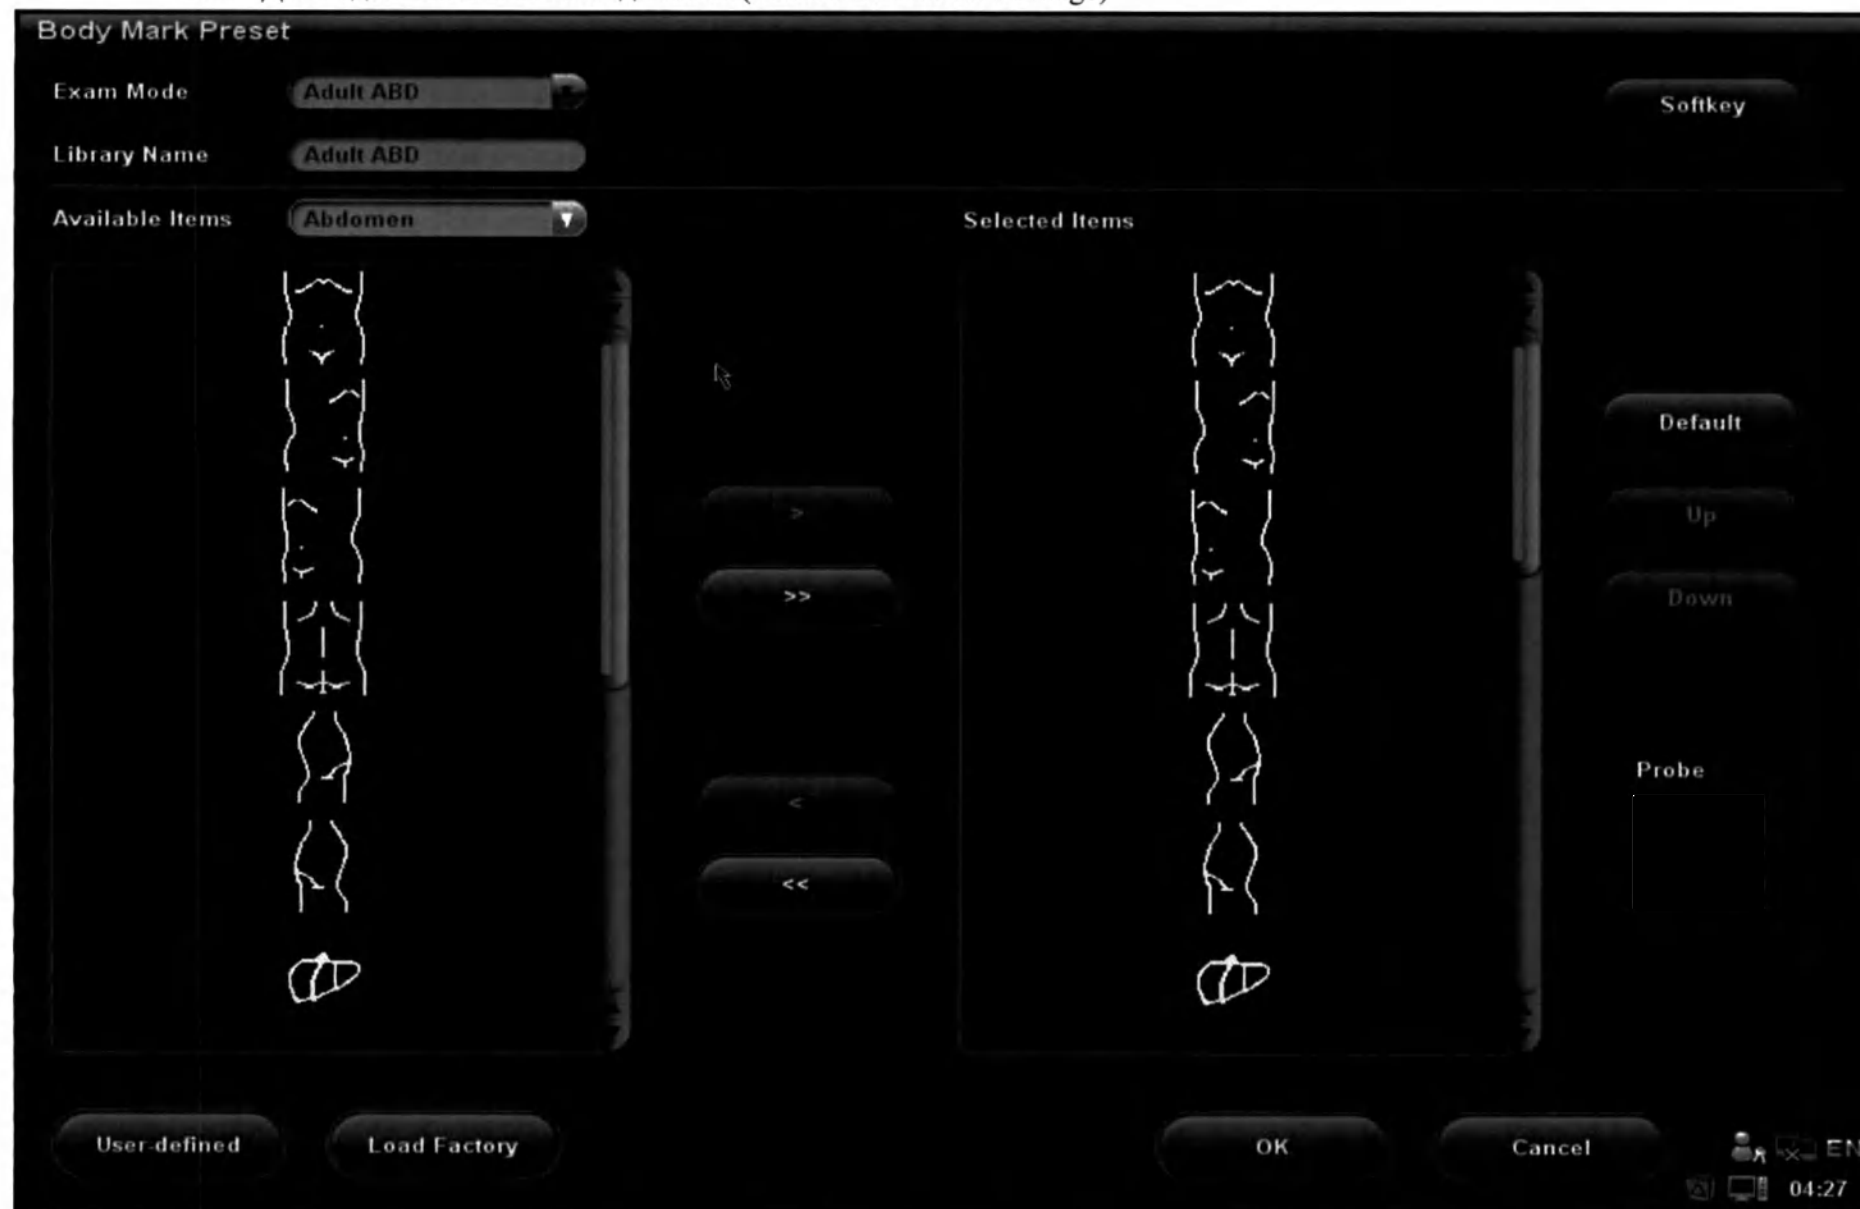

26.2. Для акушерских исследований (Obstetrics Package)



26.3. Для гинекологических исследований (Gynecology Package)

Body Mark Preset

Exam Mode:

Library Name:

Available Items:

Selected Items:

Softkey


Default

Probe

User defined Load Factory OK Cancel

01.26


26.4. Для кардиологических исследований (Cardiology Package)

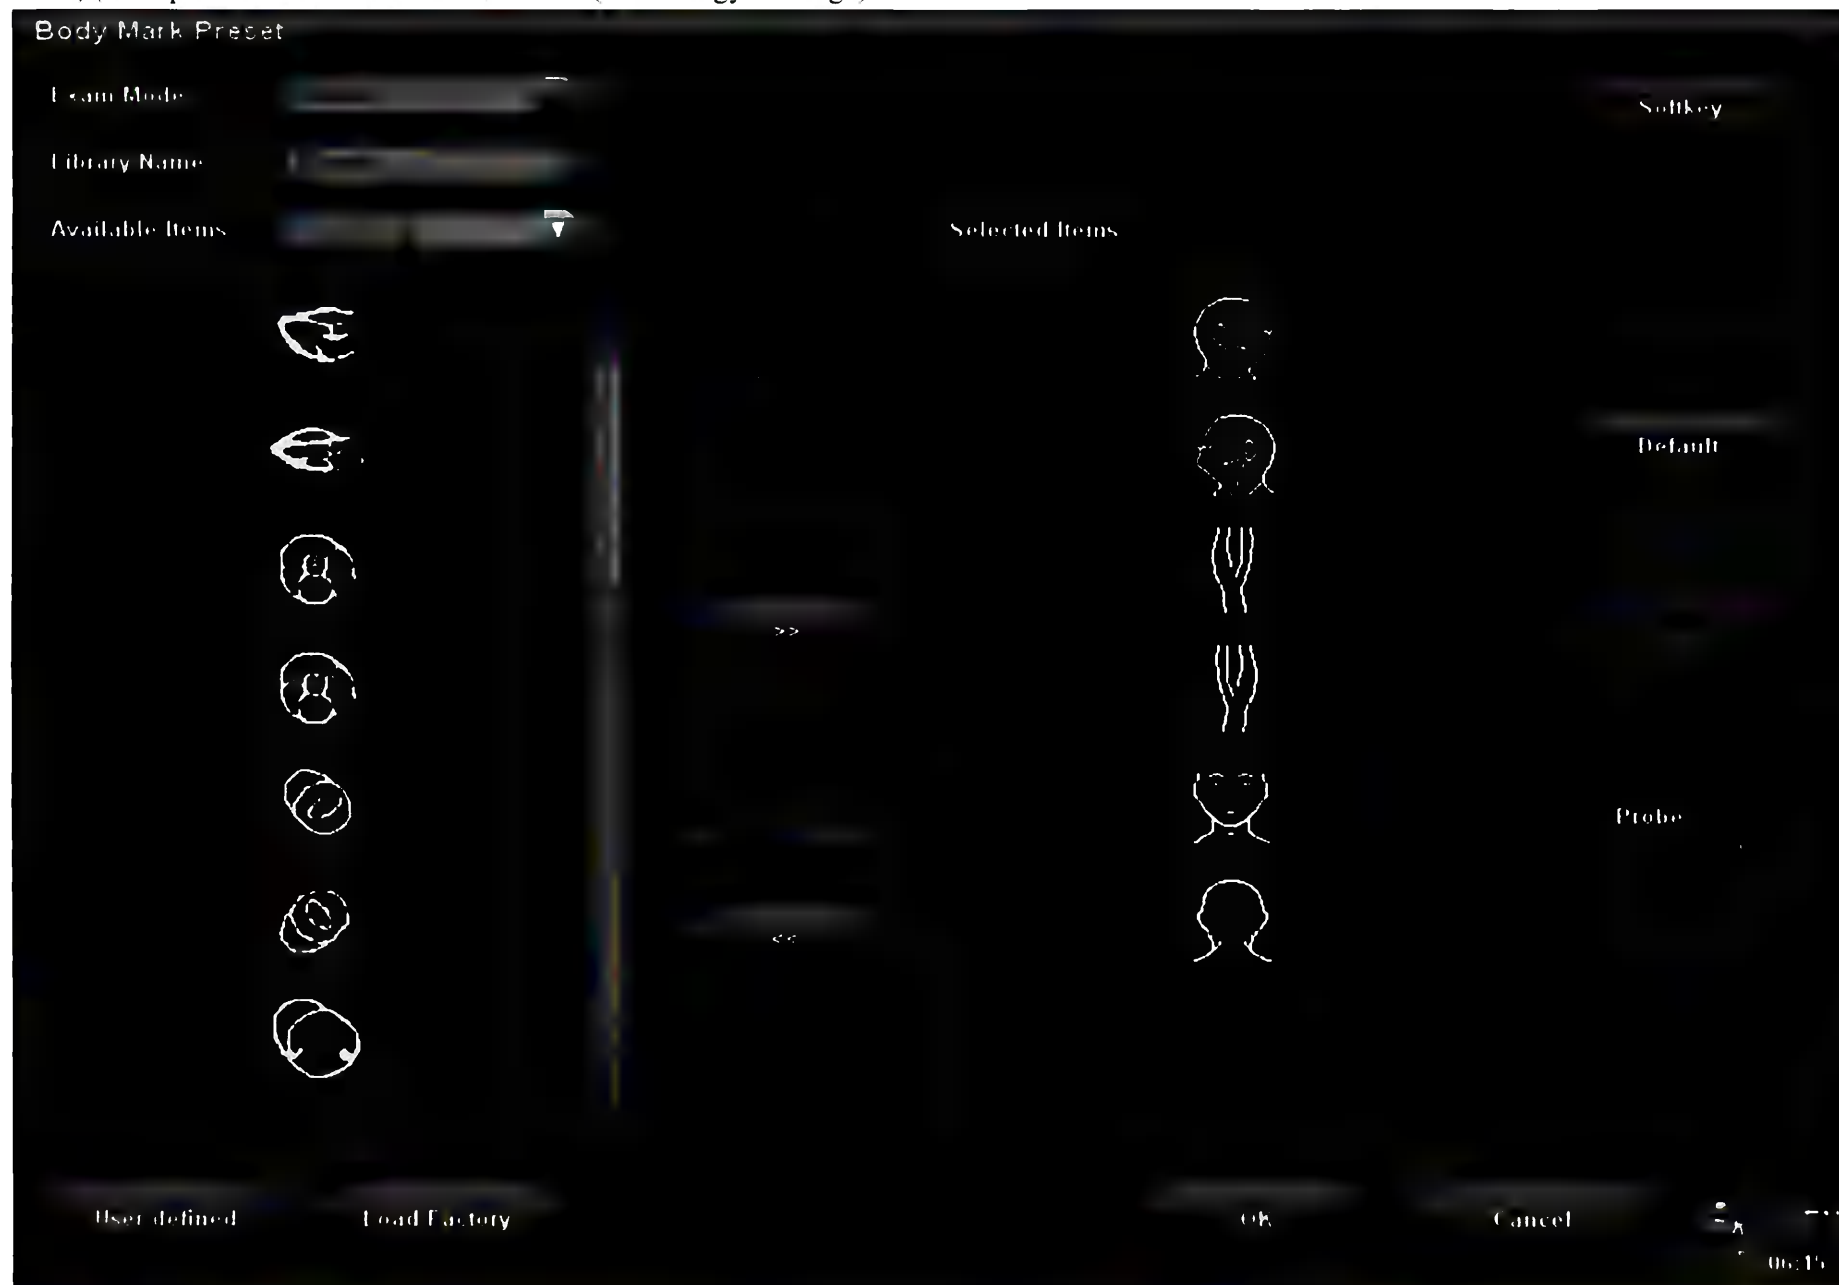


26.5. Для исследований малых органов (Small Parts Package)




26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

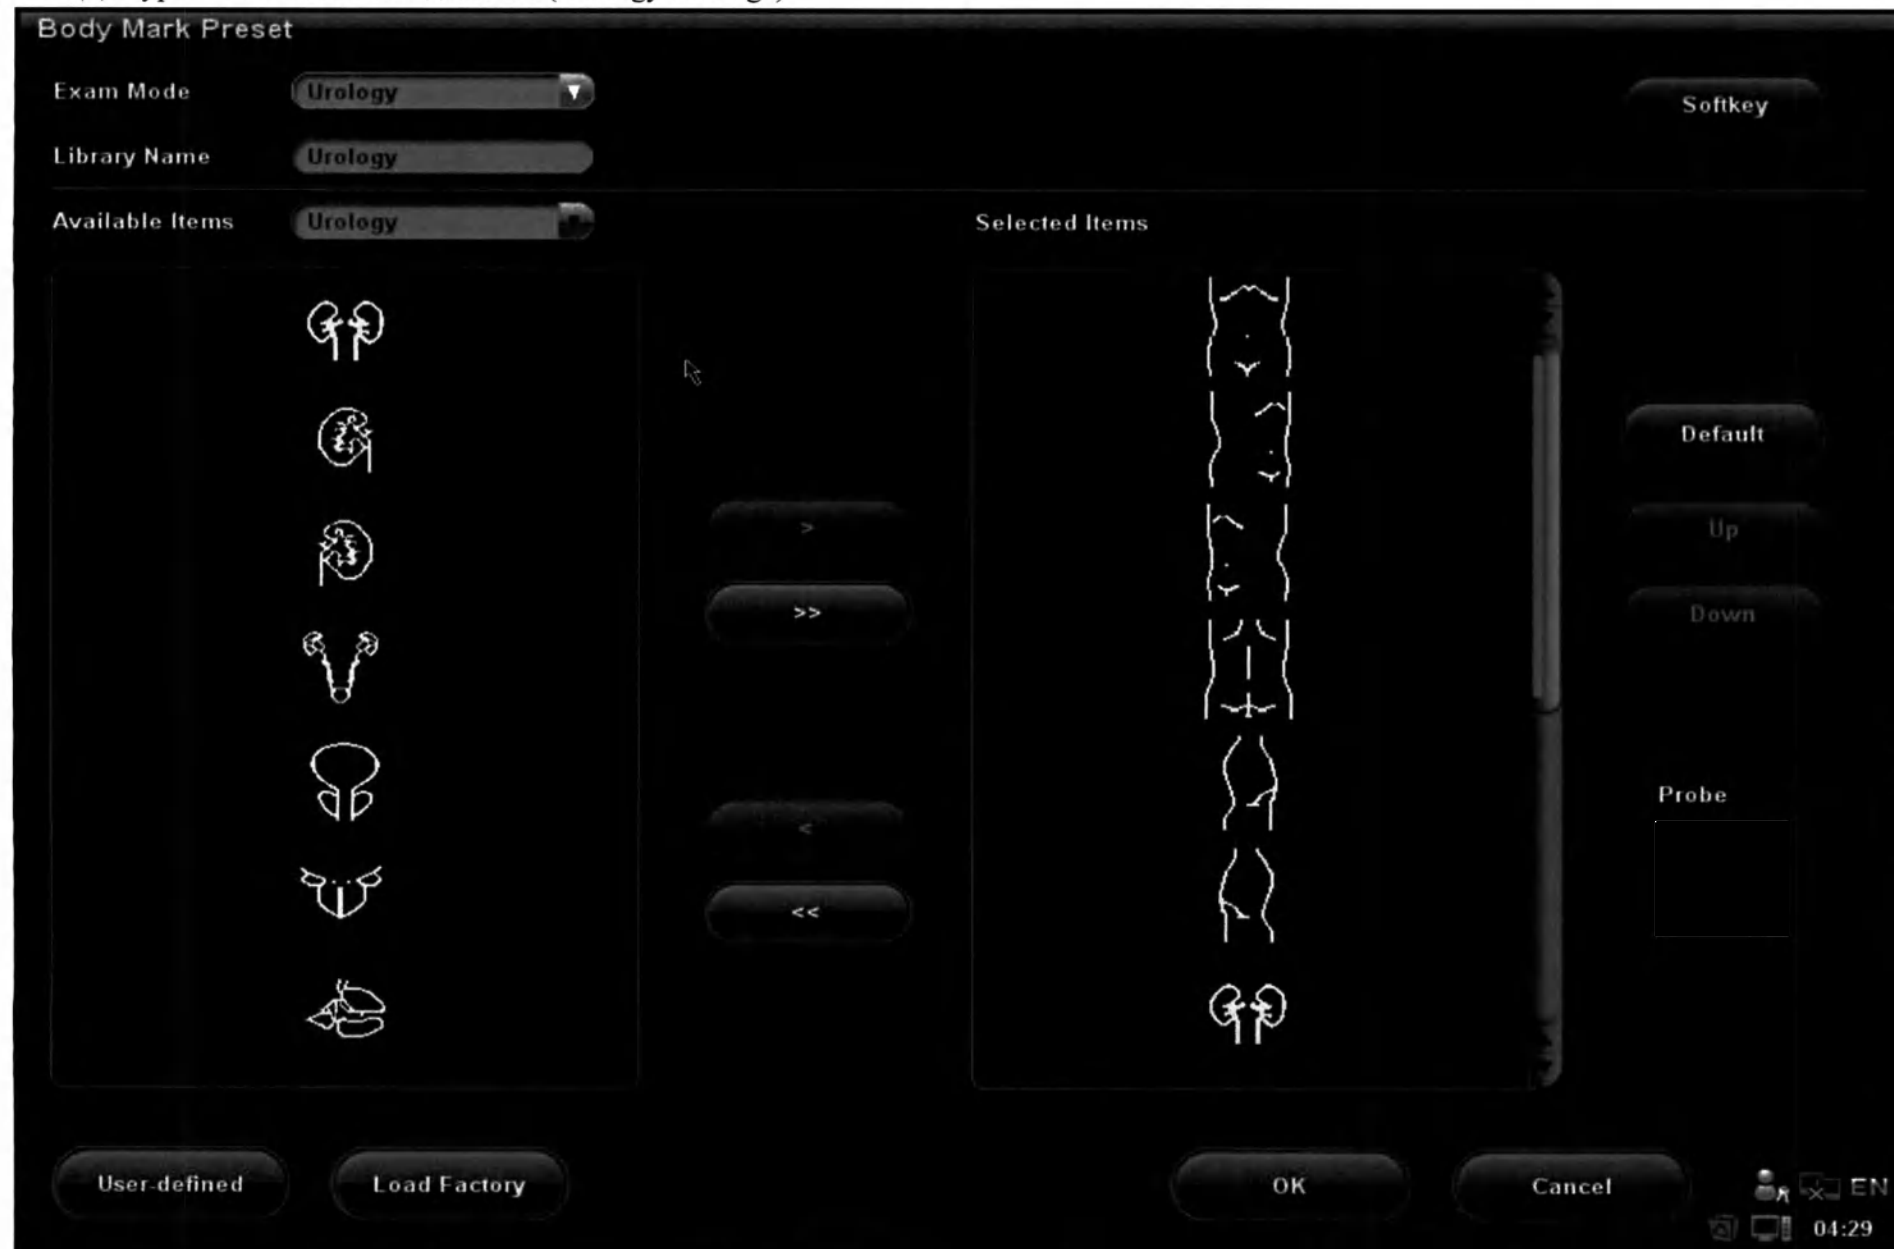


26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)

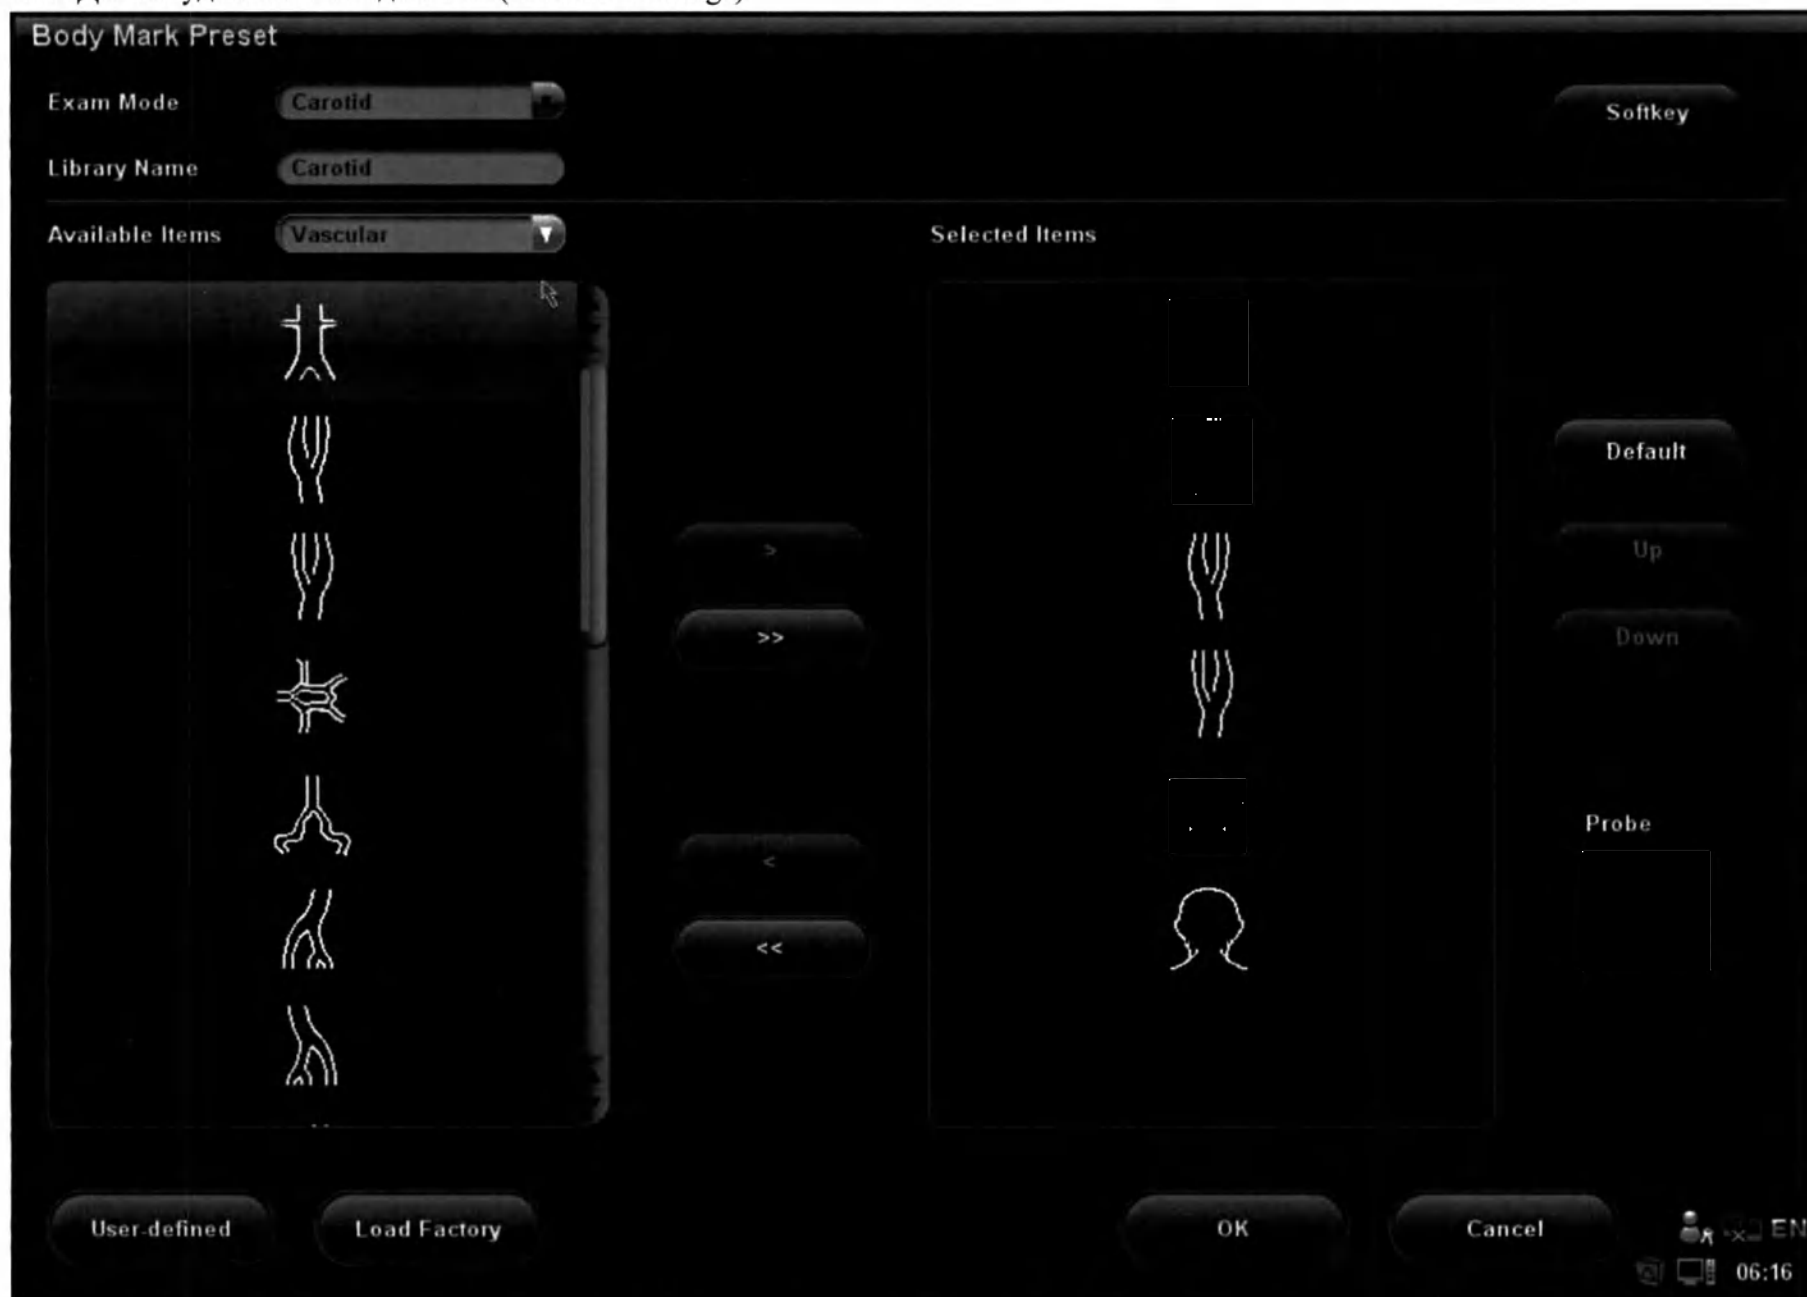


26.8. Для исследований в педиатрии (Pediatrics Package)

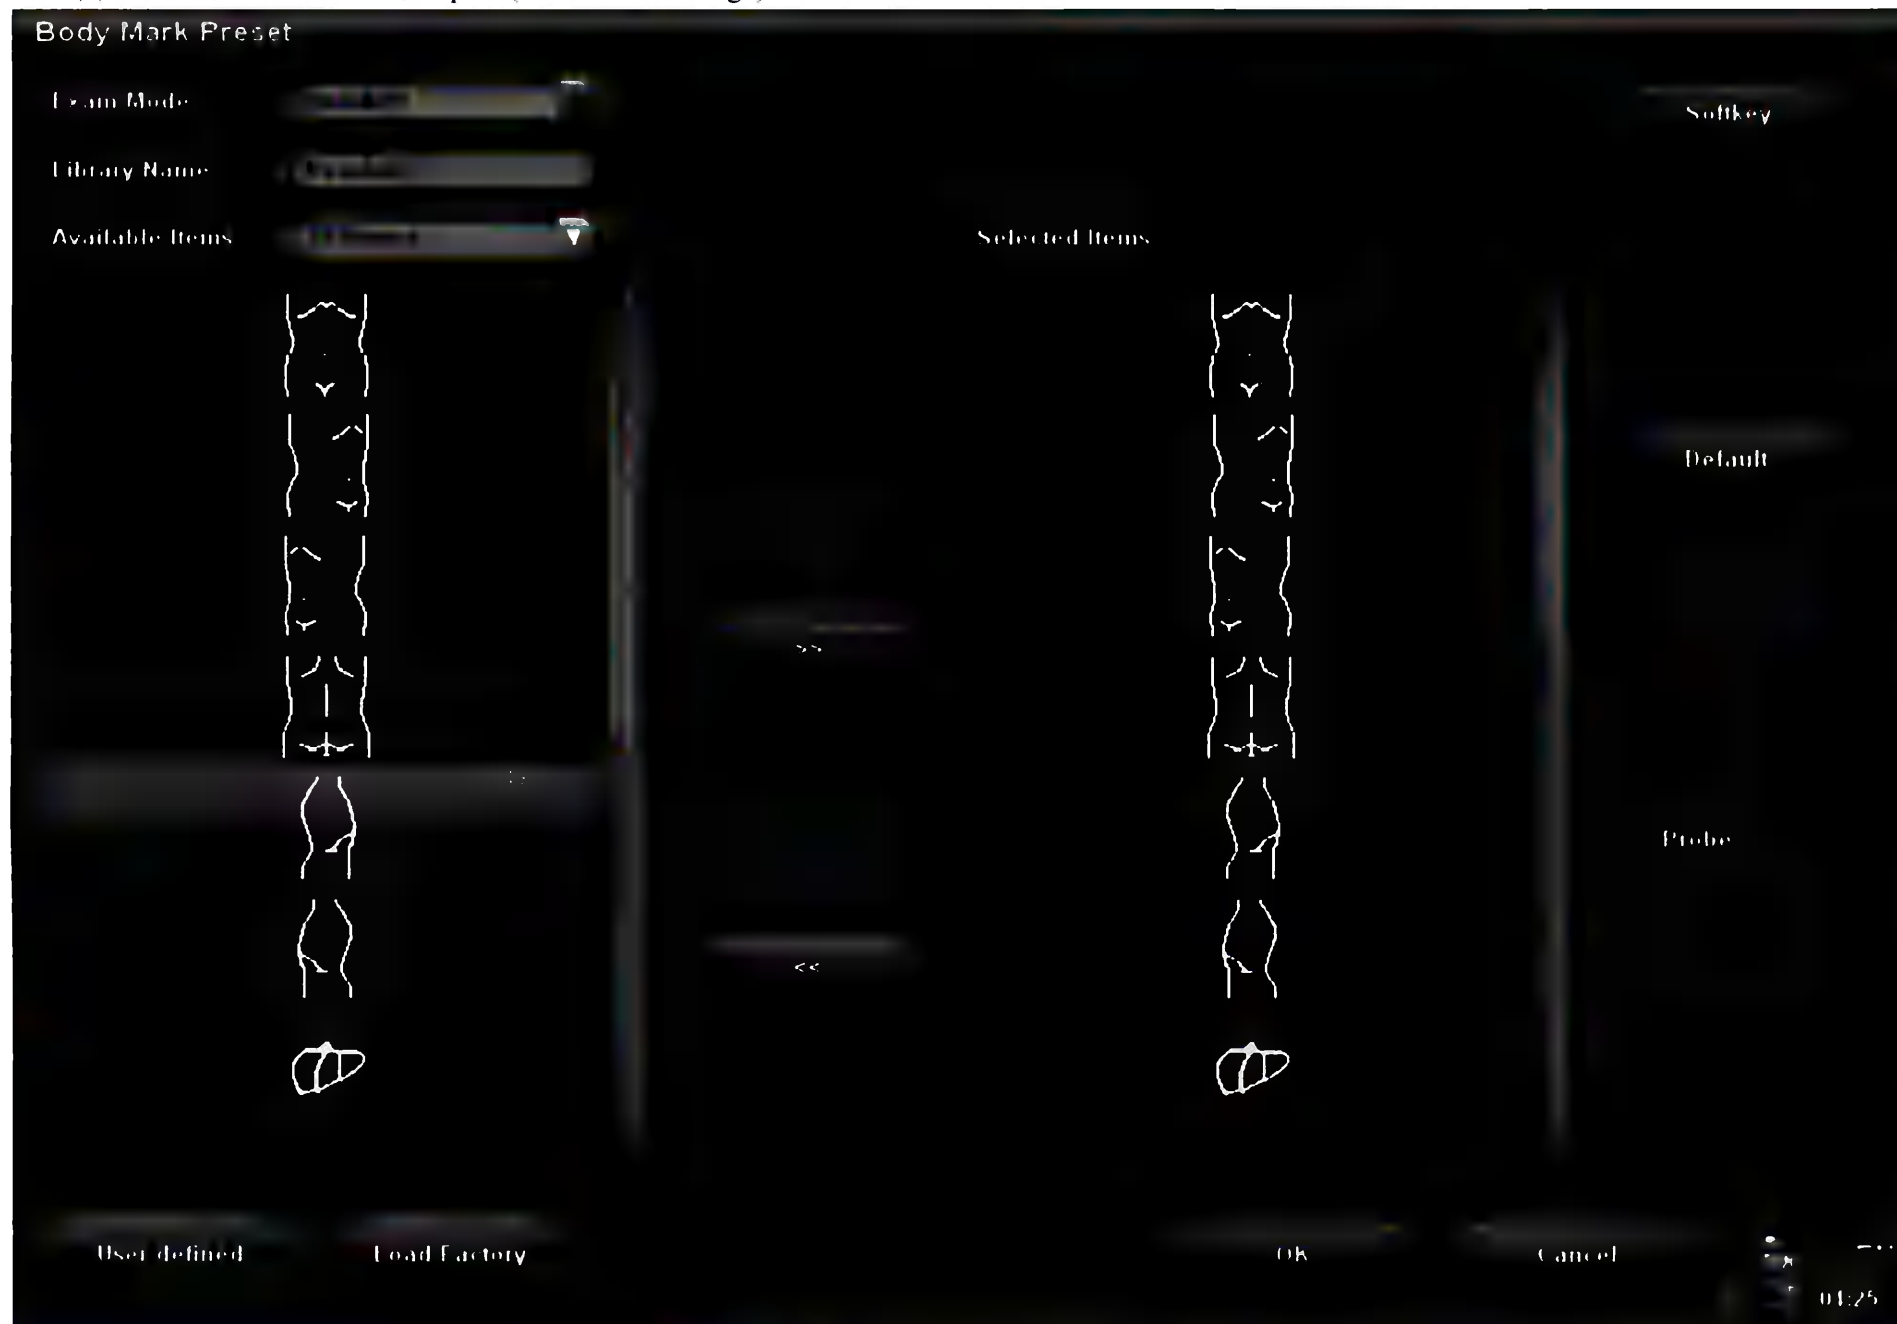


26.9. Для исследований нервов (Nerve Package)

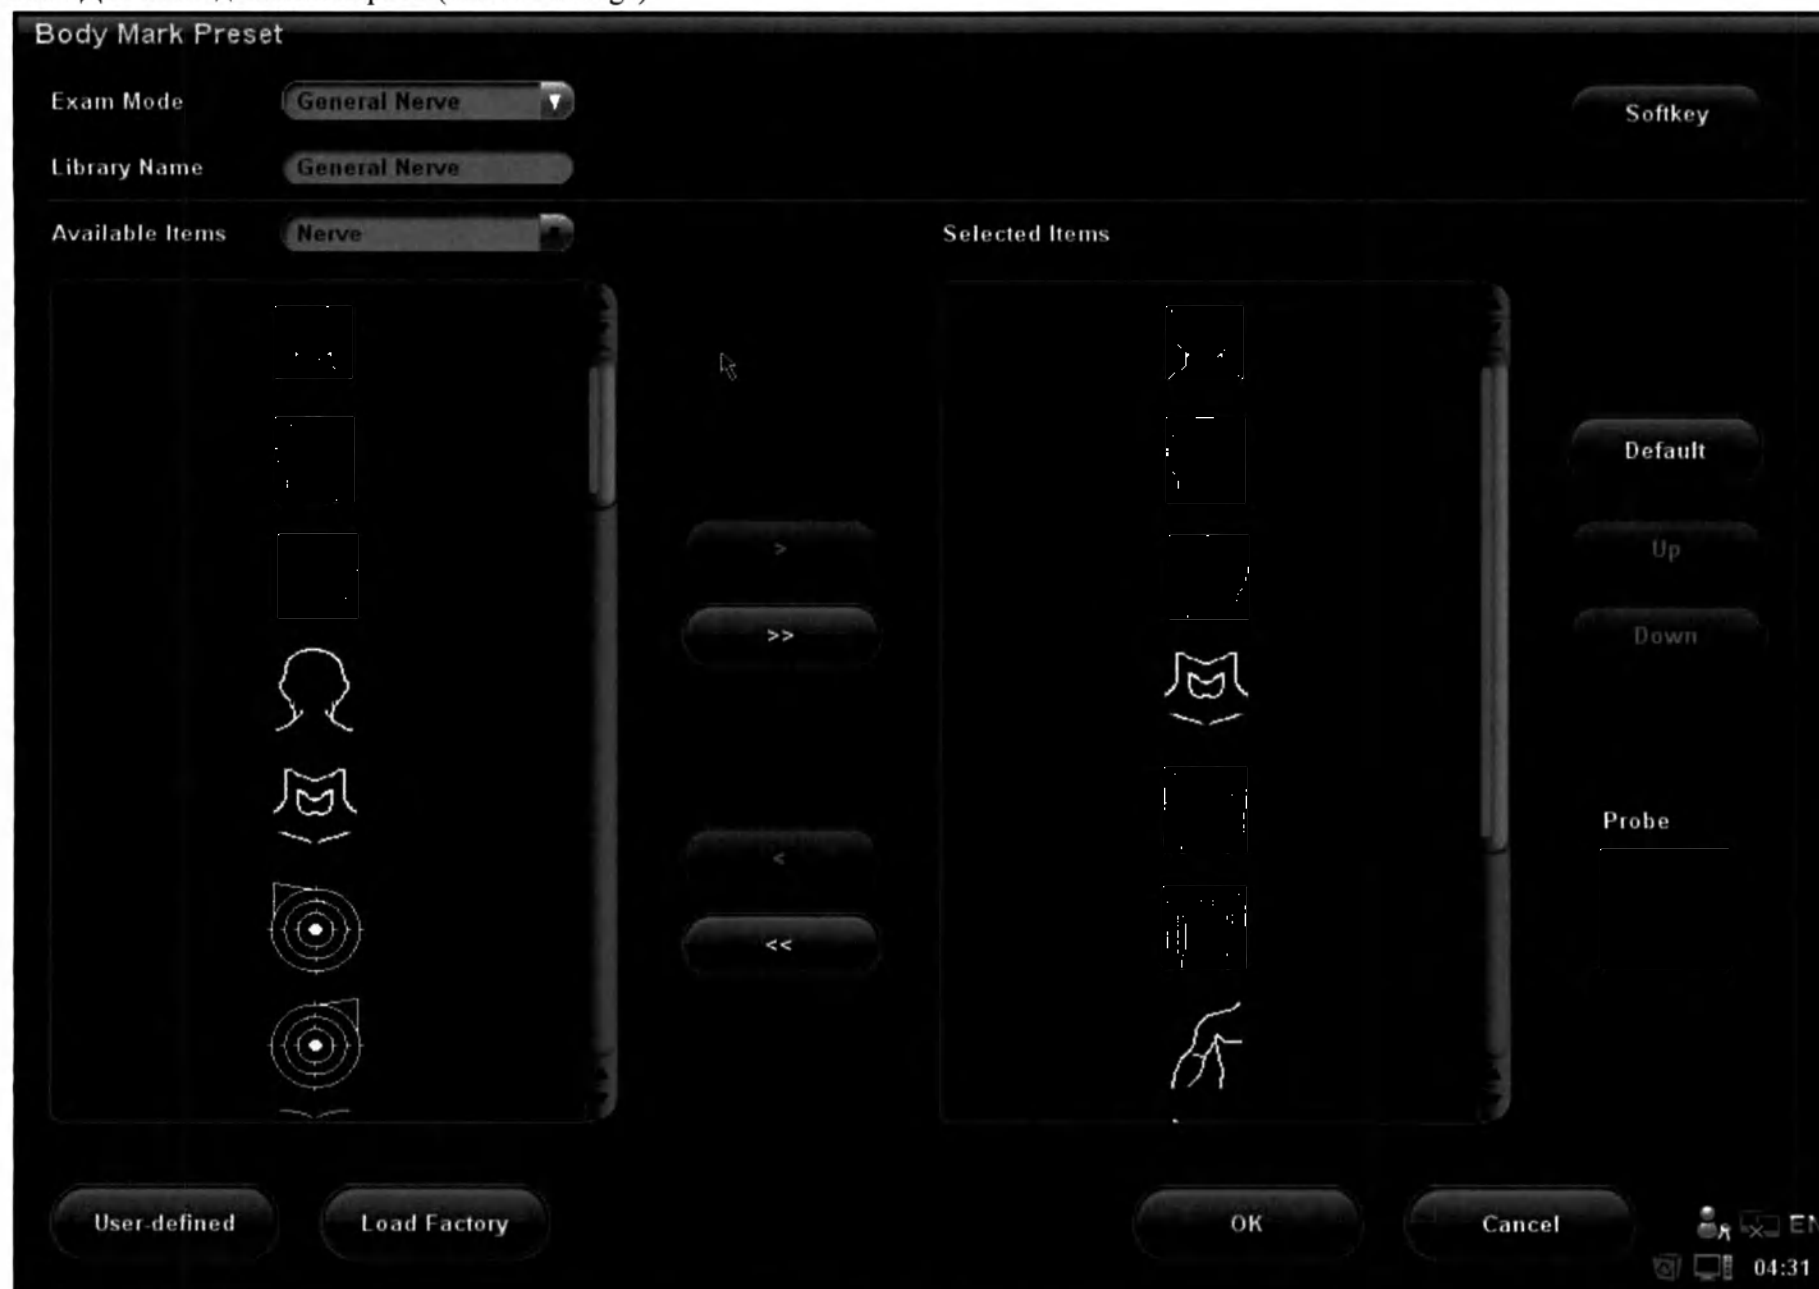

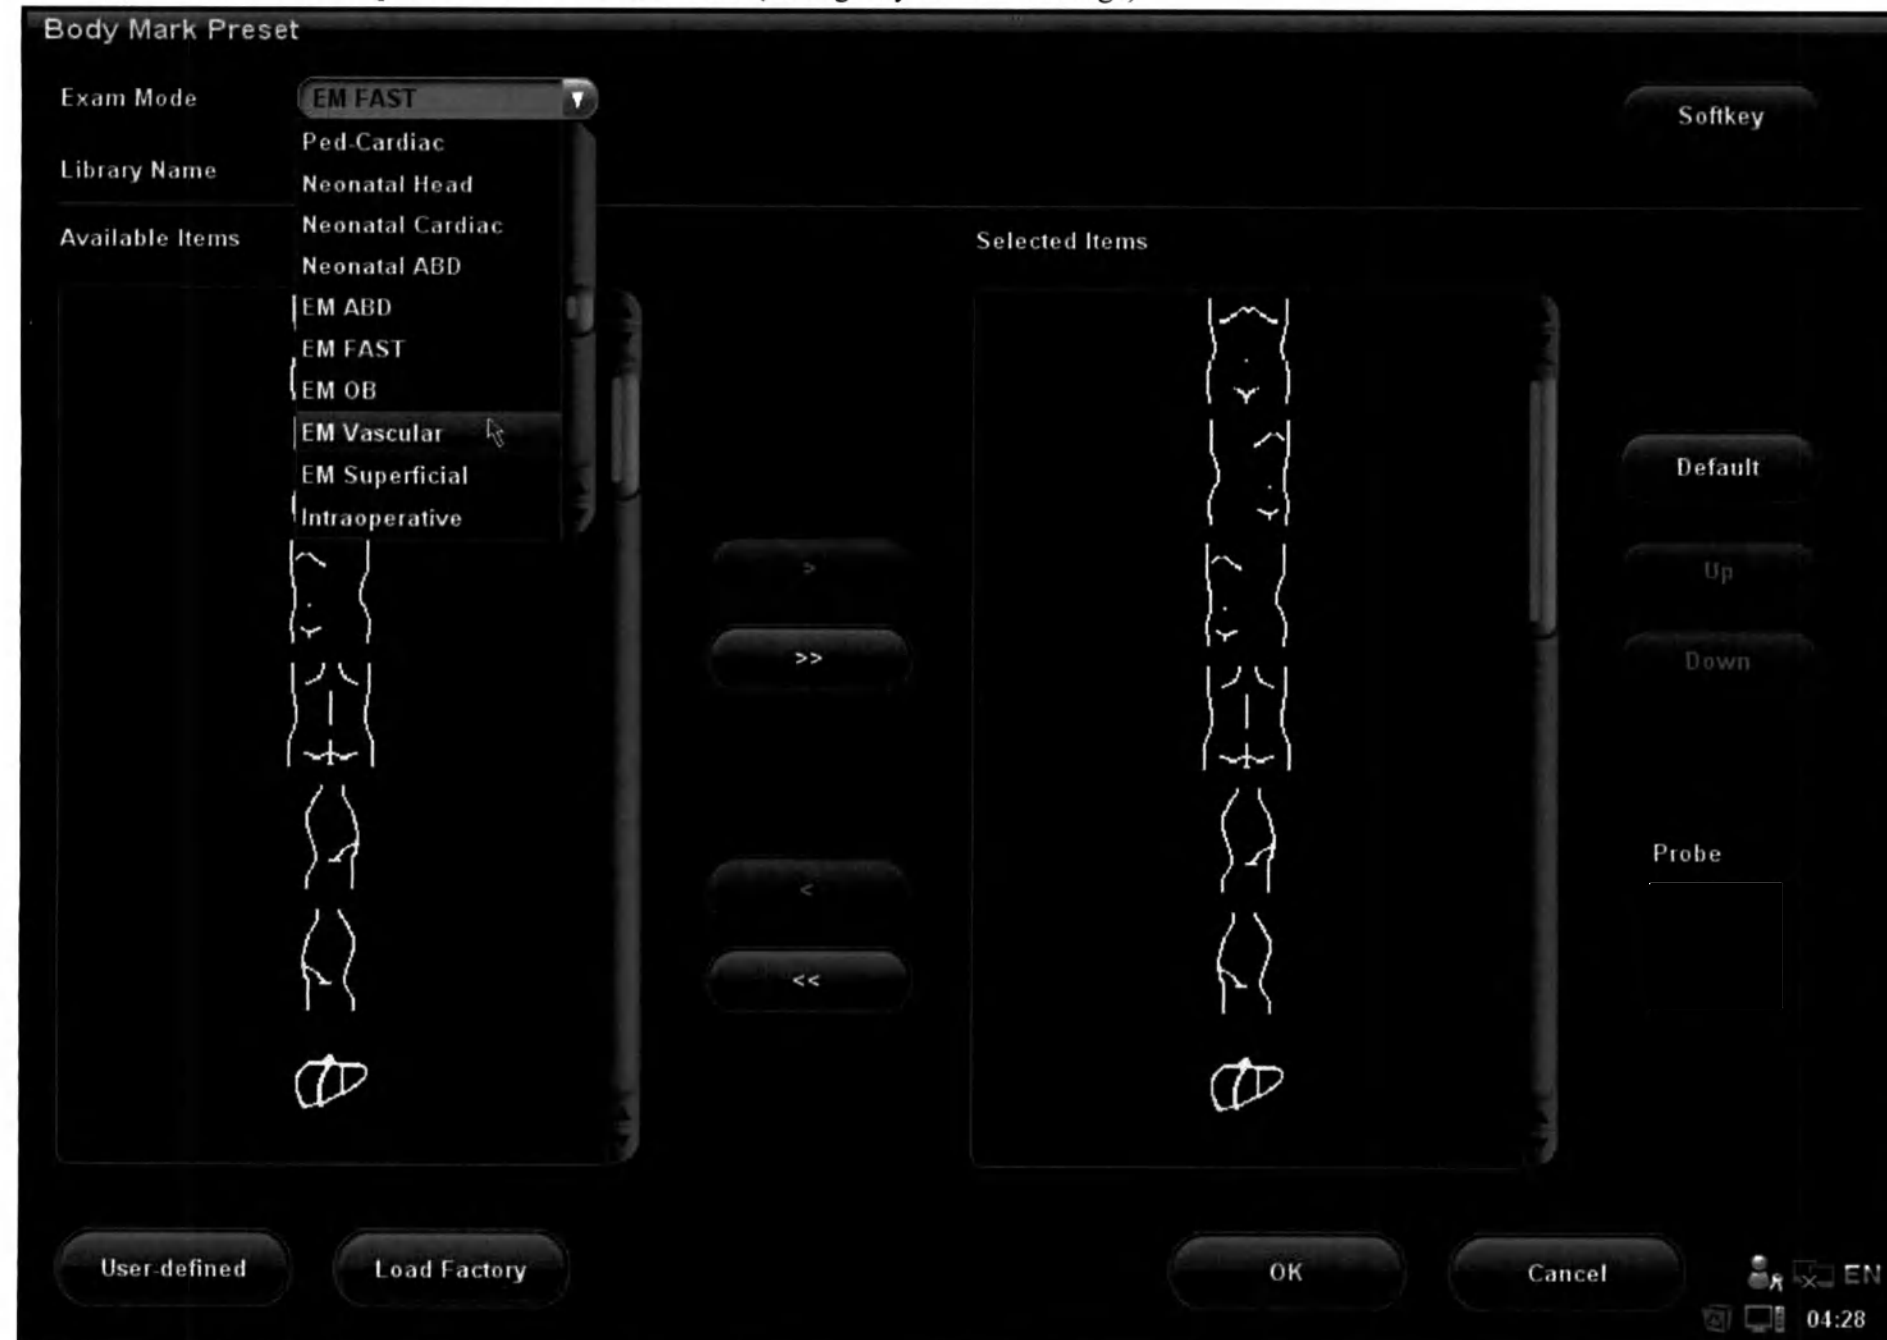

26.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)

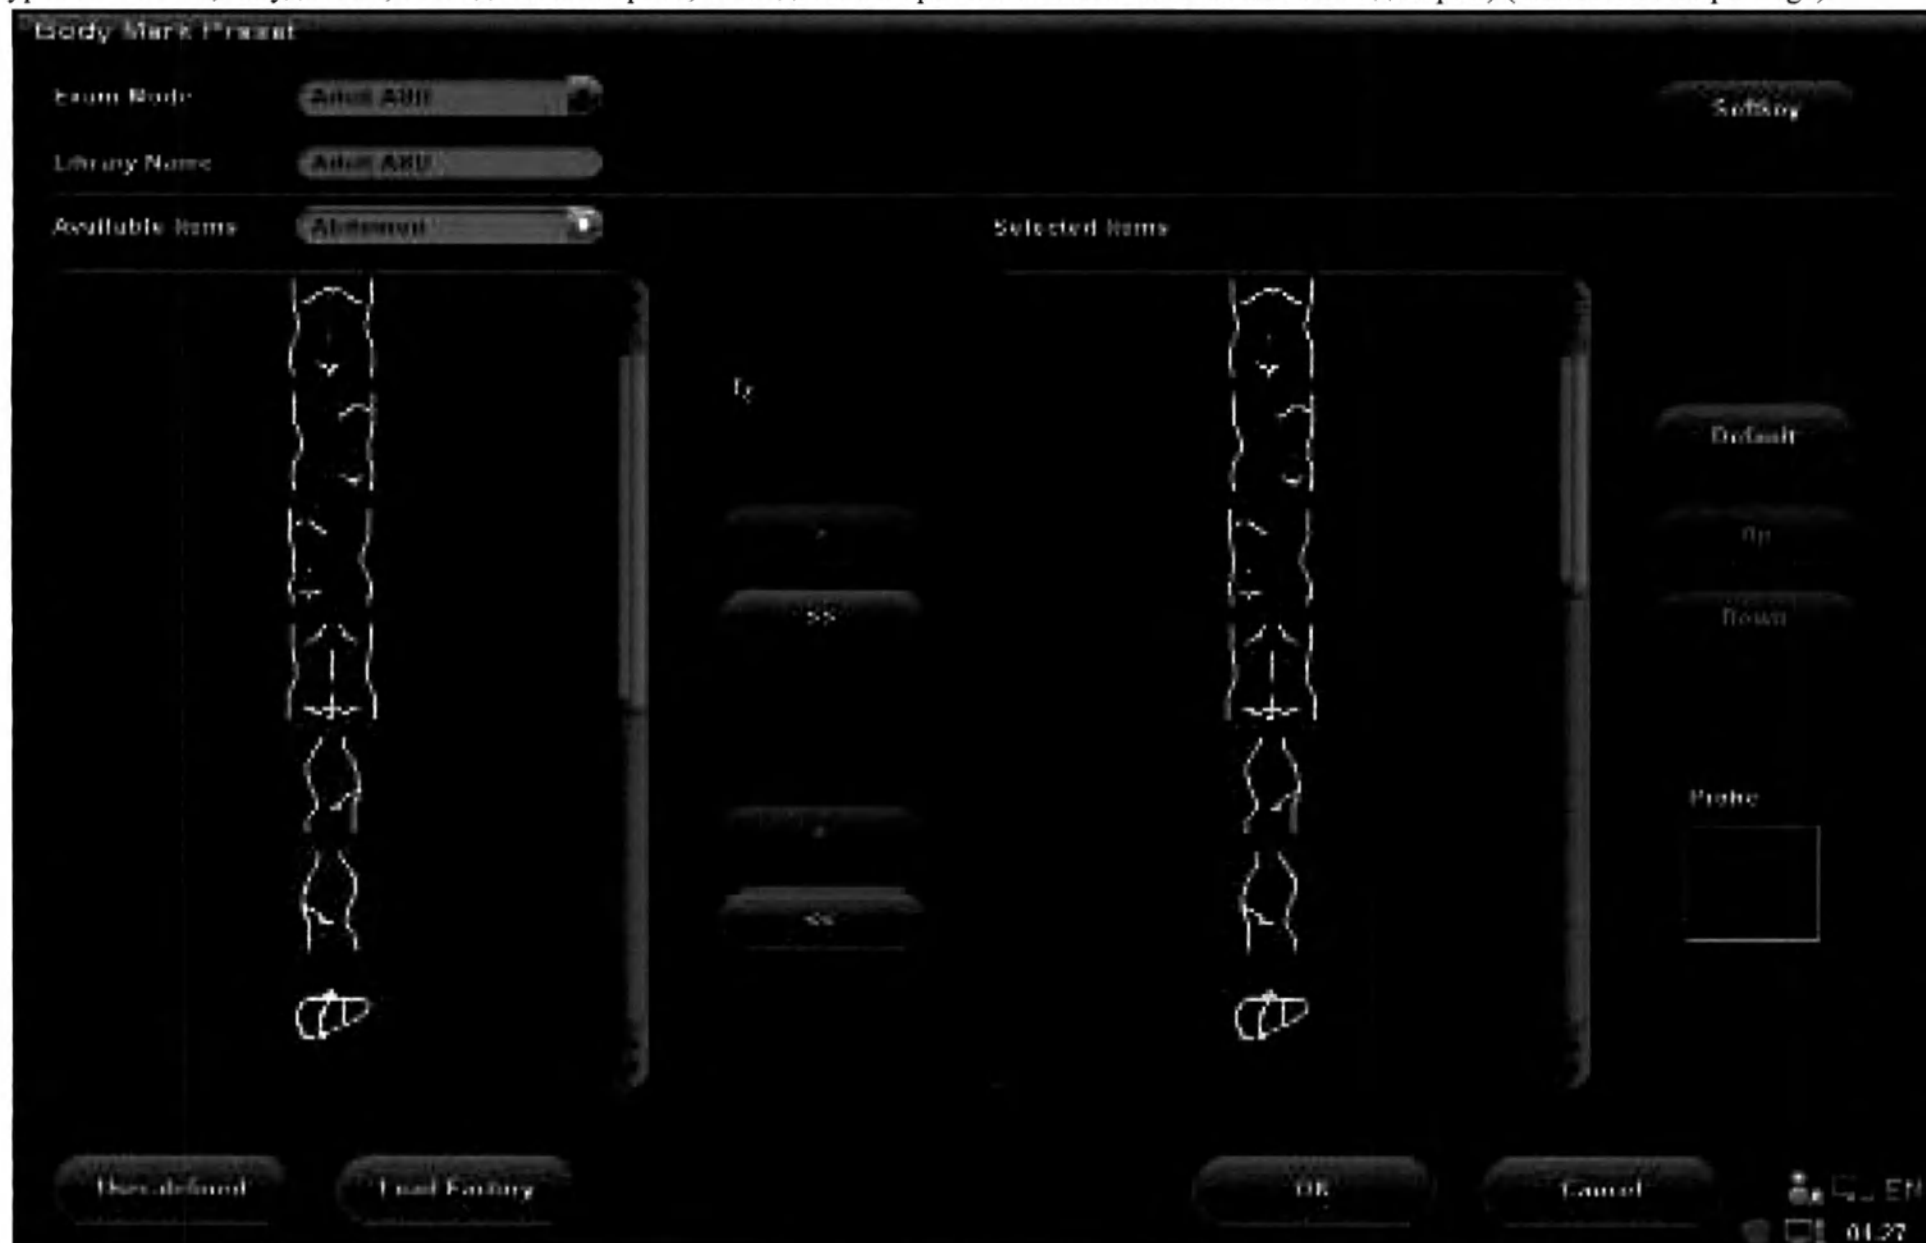











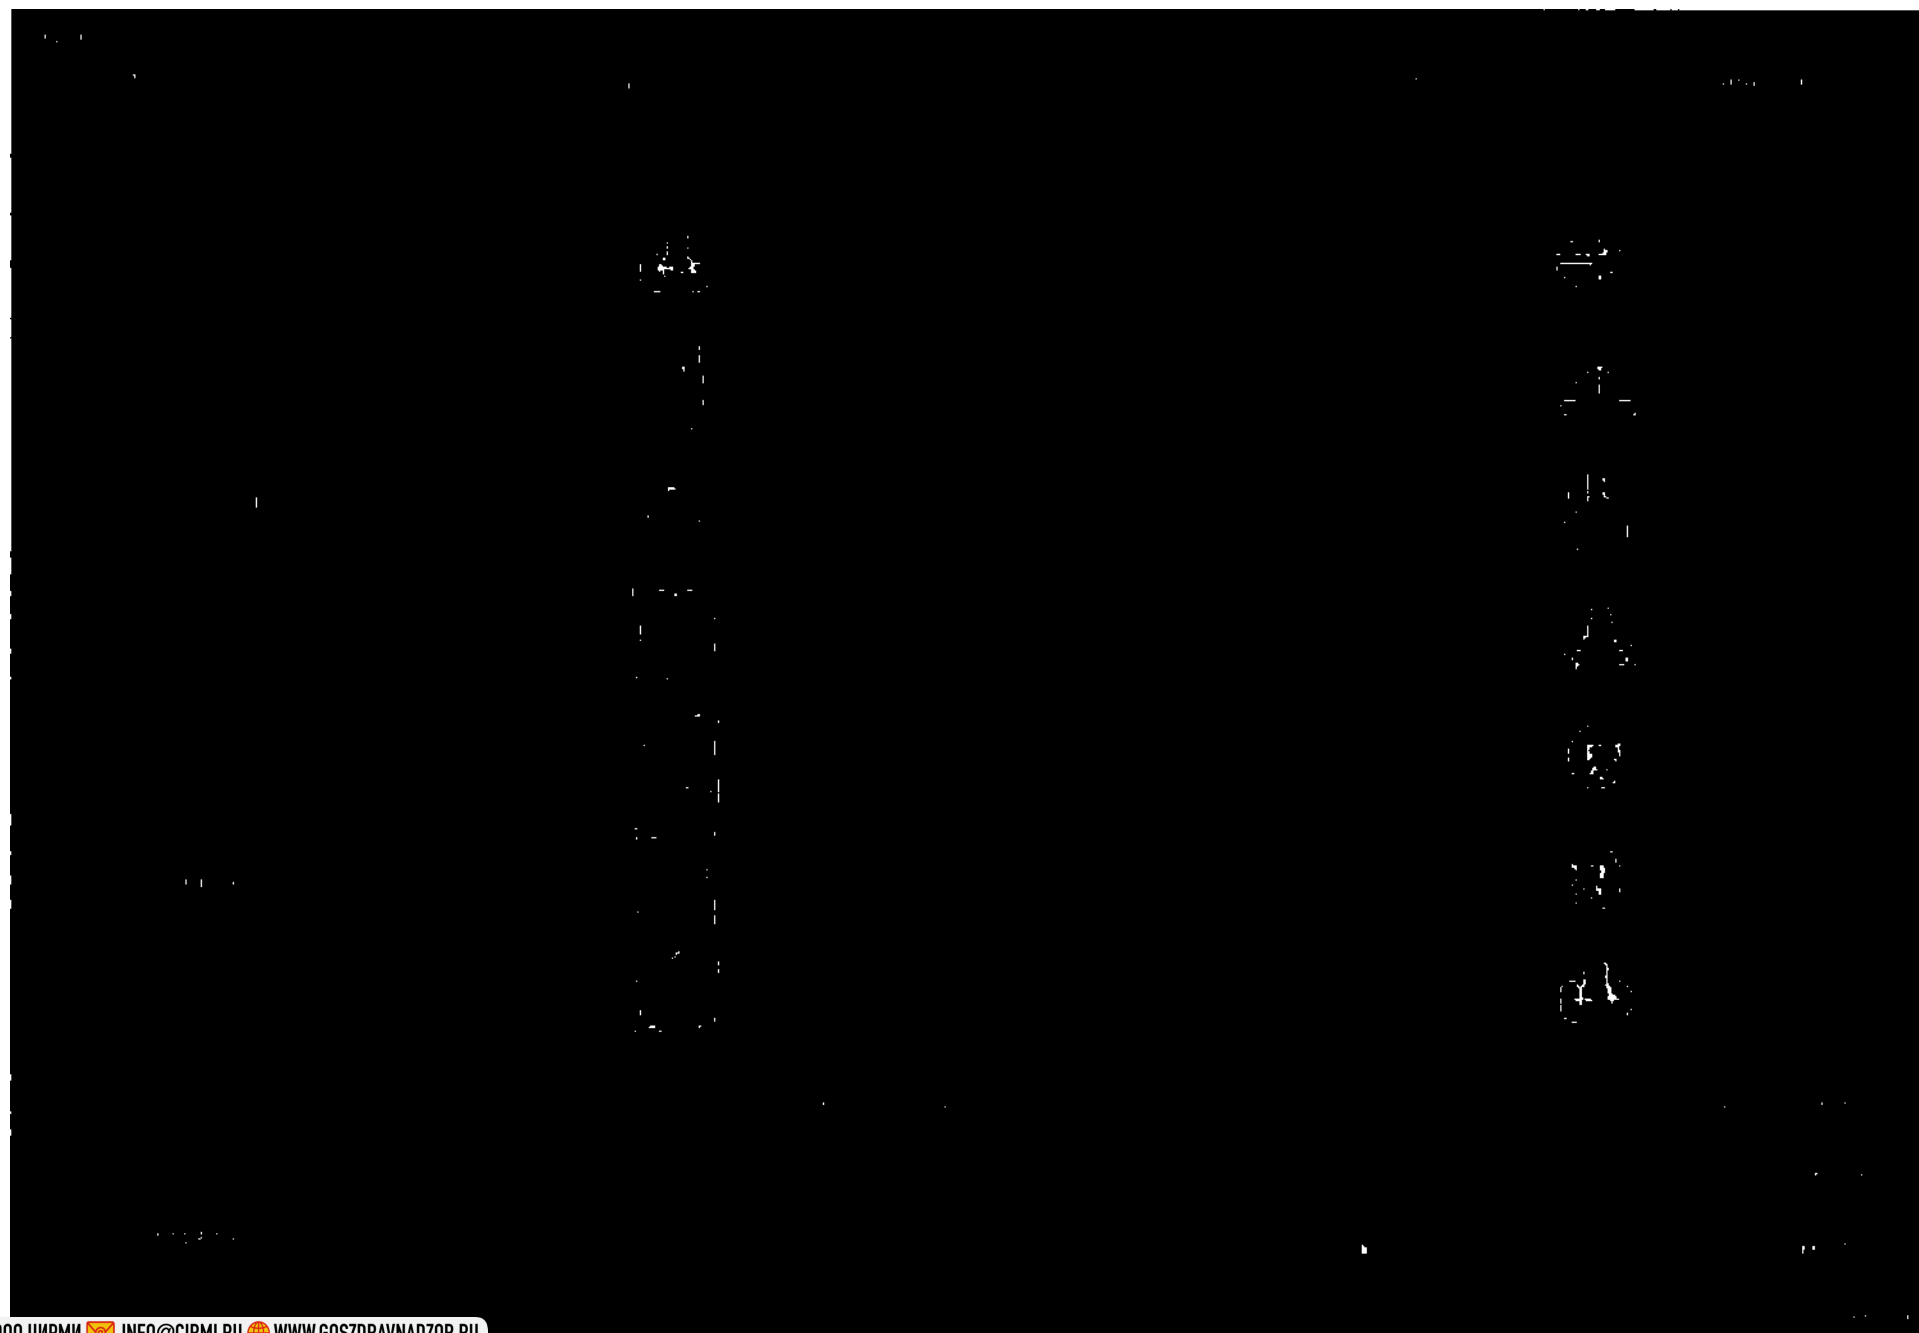

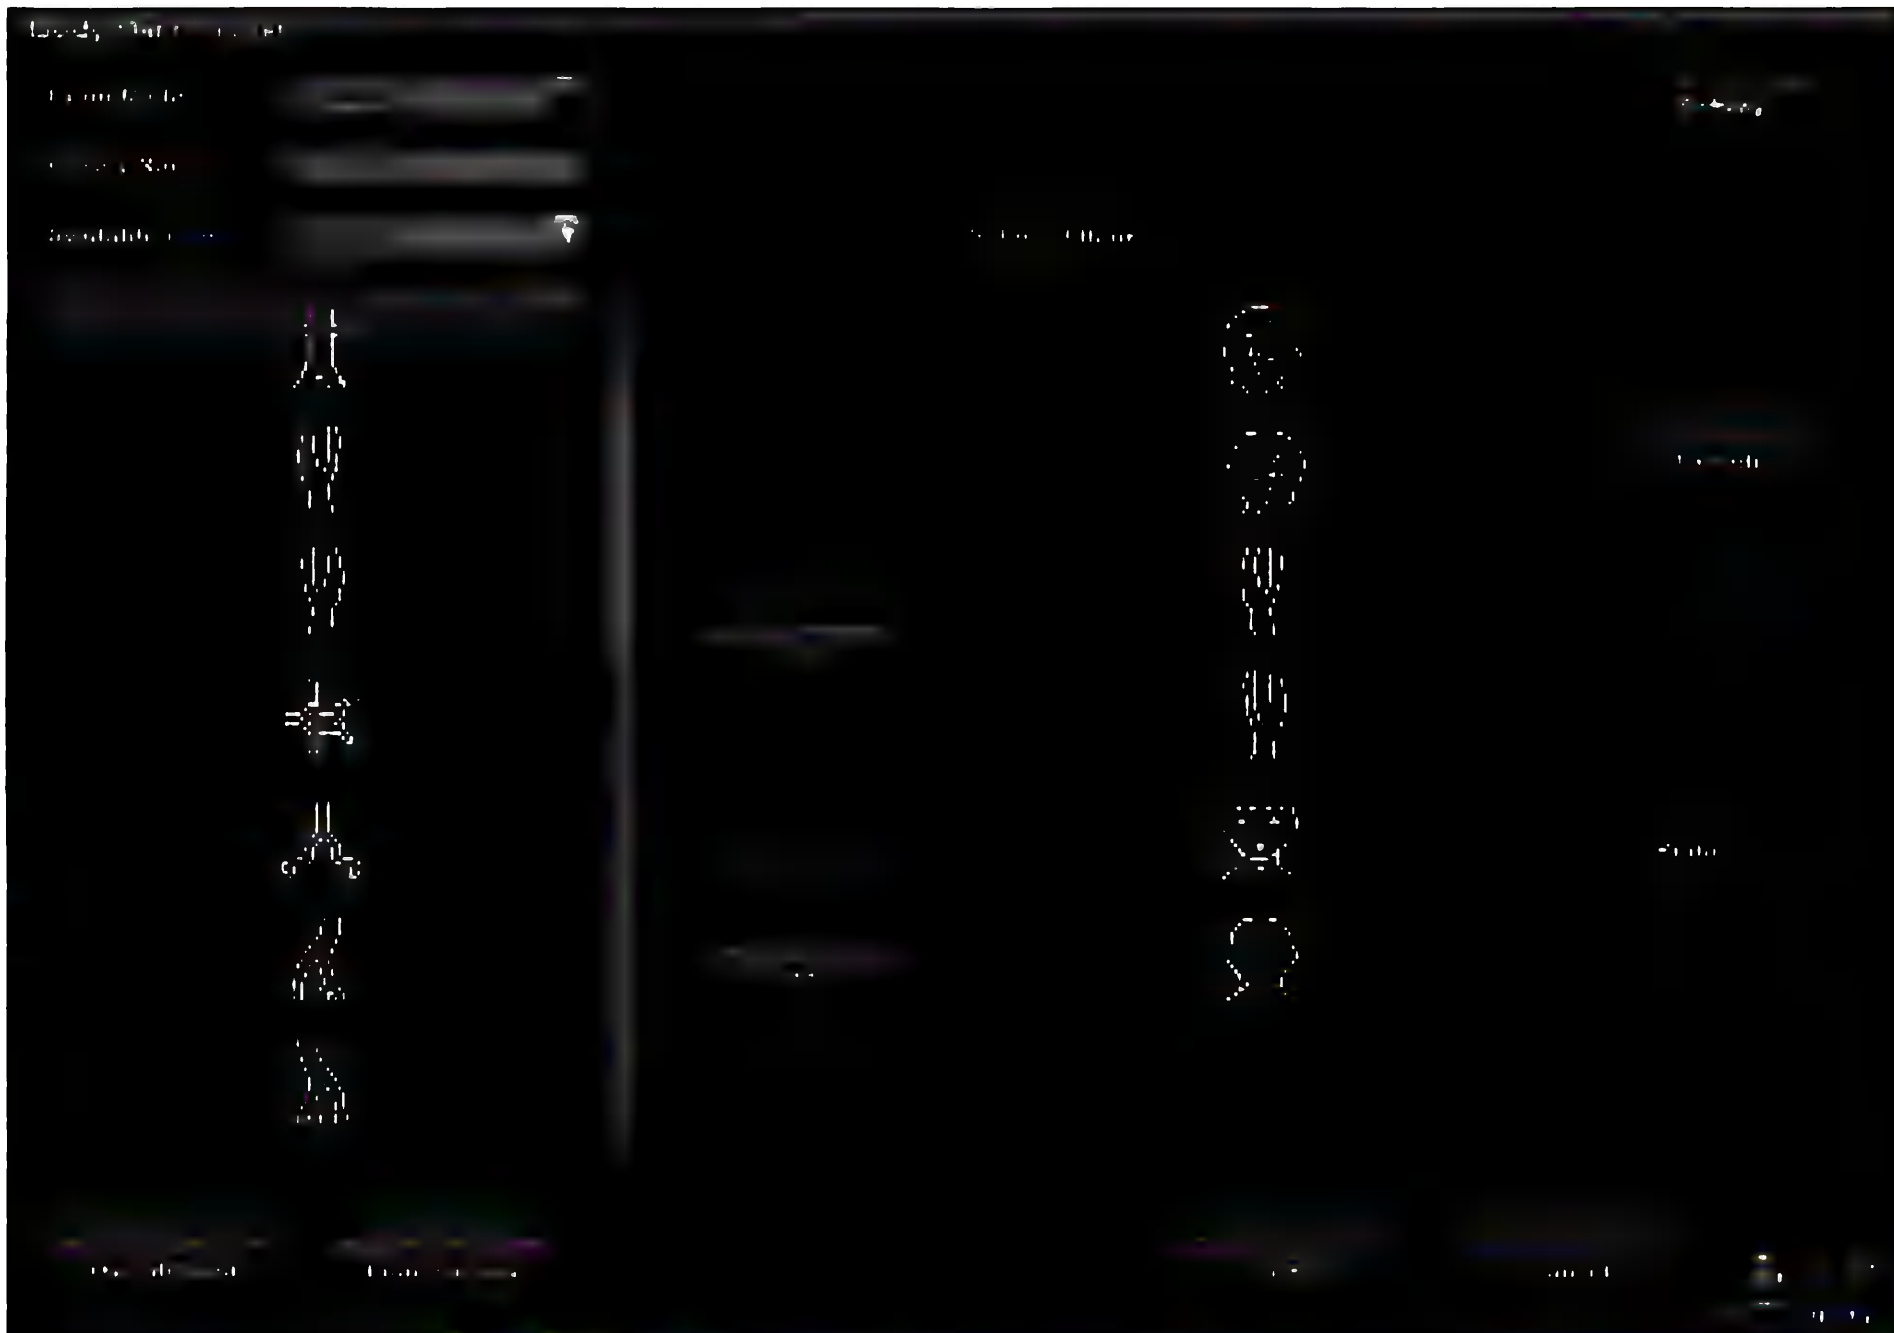




1. Введение
2. Описание объекта
3. Описание процесса
4. Описание оборудования
5. Описание персонала
6. Описание документации
7. Описание результатов
8. Заключение

1. Введение
2. Описание объекта
3. Описание процесса
4. Описание оборудования
5. Описание персонала
6. Описание документации
7. Описание результатов
8. Заключение

1

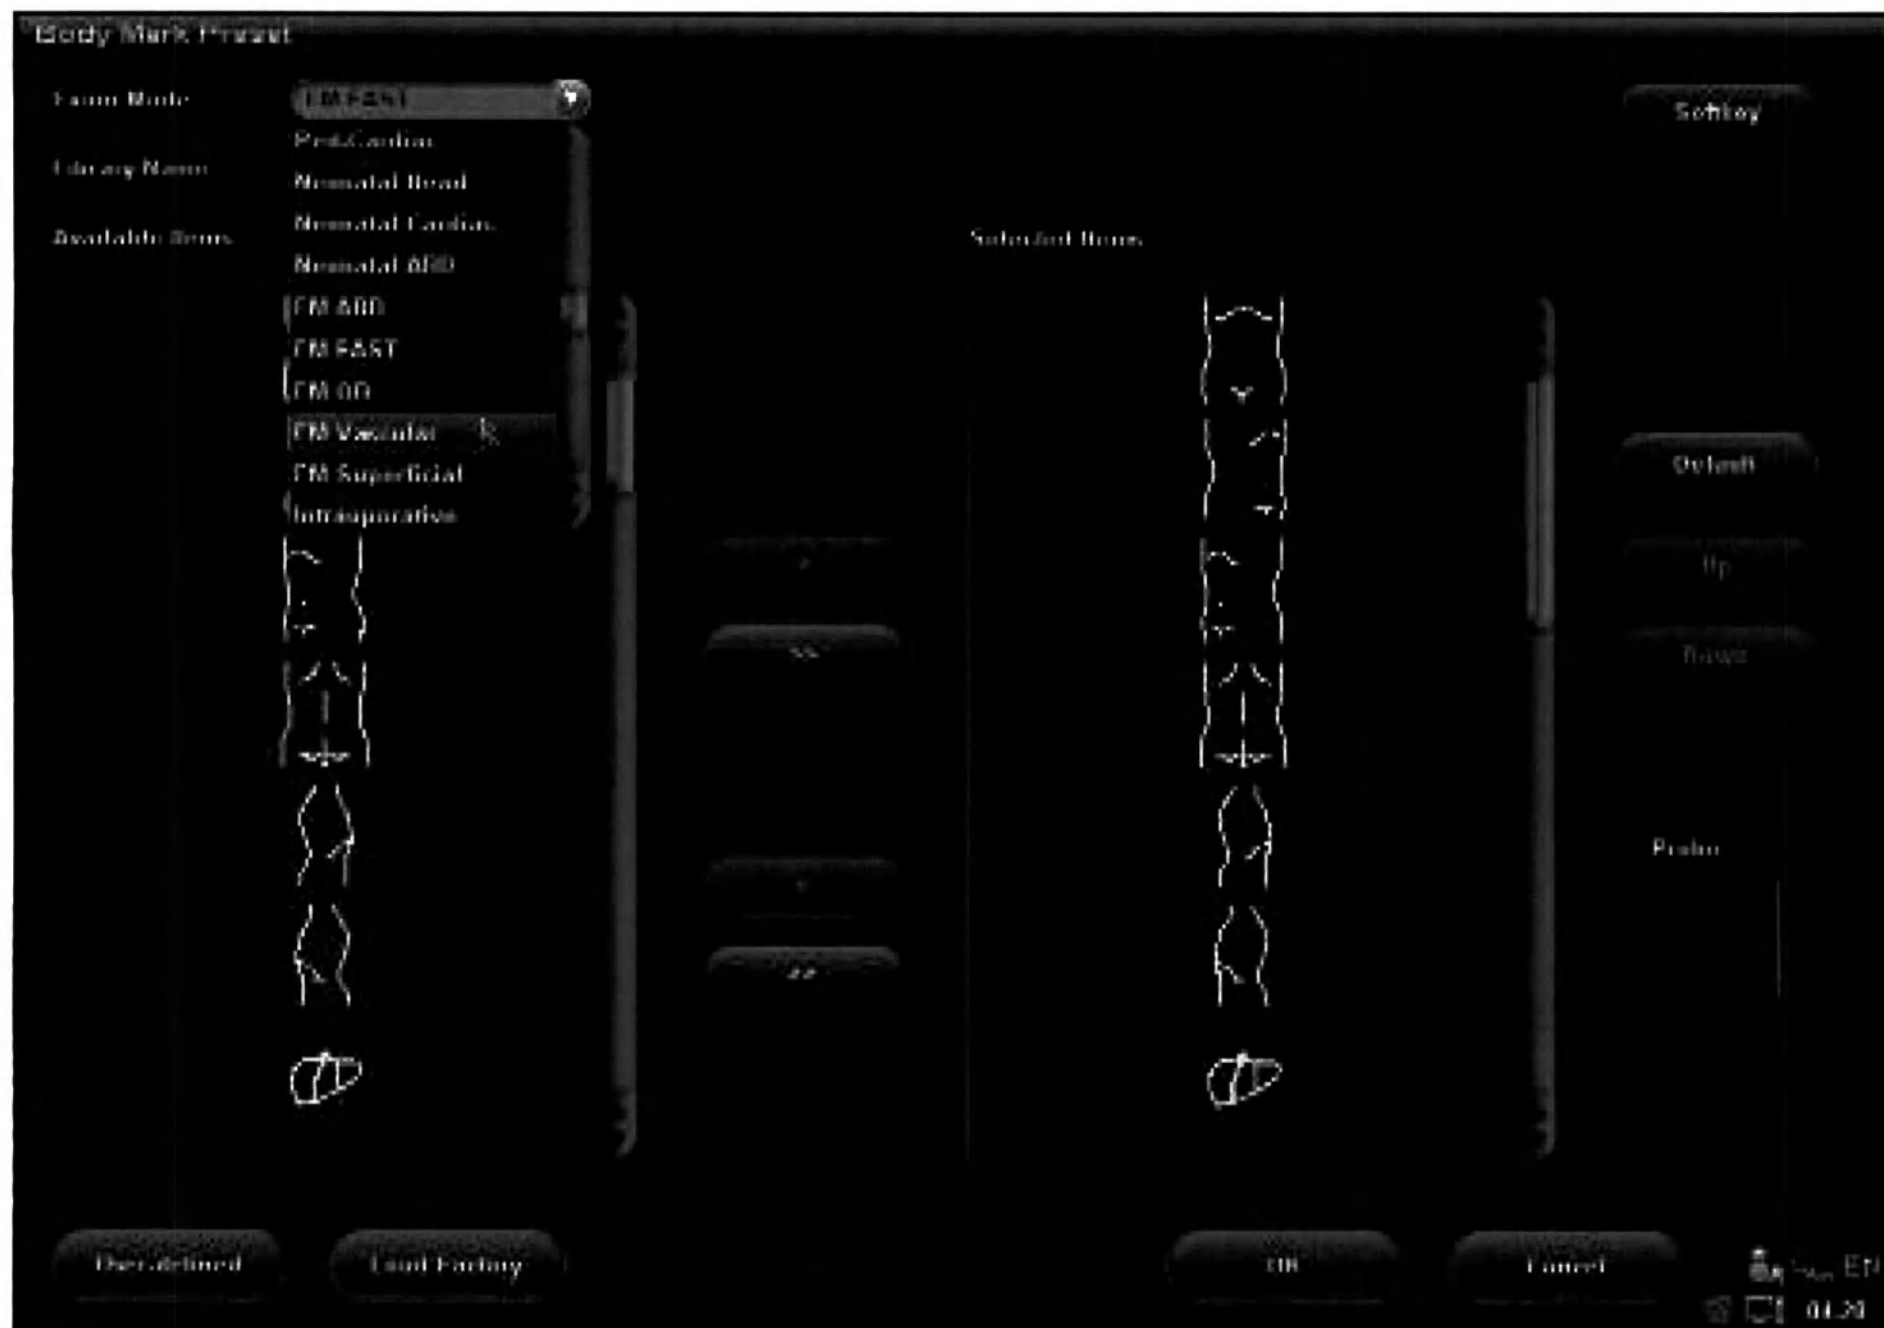

26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage | Print | Worklist | MPPS | StorageCommitment | Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Storage		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Storage Print **Worklist** MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device Service Name AE Title Port
 Maximum Retries Interval Time(Sec) Timeout(Sec)
 Scheduled Station AE Title

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Worklist		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 03:36

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage Print Worklist **MPPS** StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device Service Name AE Title Port

Maximum Retries Interval Time(Sec) Timeout(Sec)

Add Cancel Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 03:37

26.15. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-QueryRetrieve

AE Title

Port

104

Maximum Retries

1

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-QueryRetrieve		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
☒ Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option

Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Add
Cancel

Service List

	Device		Default
1	12	12-Storage	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33

26.17. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR)

DICOM Service

Storage Print Worklist MPPS StorageCommitment Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: 12 Service Name: 12-Storage AE Title: Port: 104

Maximum Retries: 3 Interval Time(Sec): 15 Timeout(Sec): 15

Cine Zoom Mode: Original Compression Mode: RLE Compression Ratio: Lossless

Color Mode: Color ☒ Allow Multiframe Max Framerate: 35

SR Storage Option: Not Store SR

Add Cancel

Service List

	Device		Default
1	12	Not Store SR	N

Delete Default Verify Verification is required!

Exit

EN 02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
☒ Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option

Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements
Not Store SR

Add
Cancel


Service List

	Device		Default
1	12	12-Storage	N


Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33


26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)

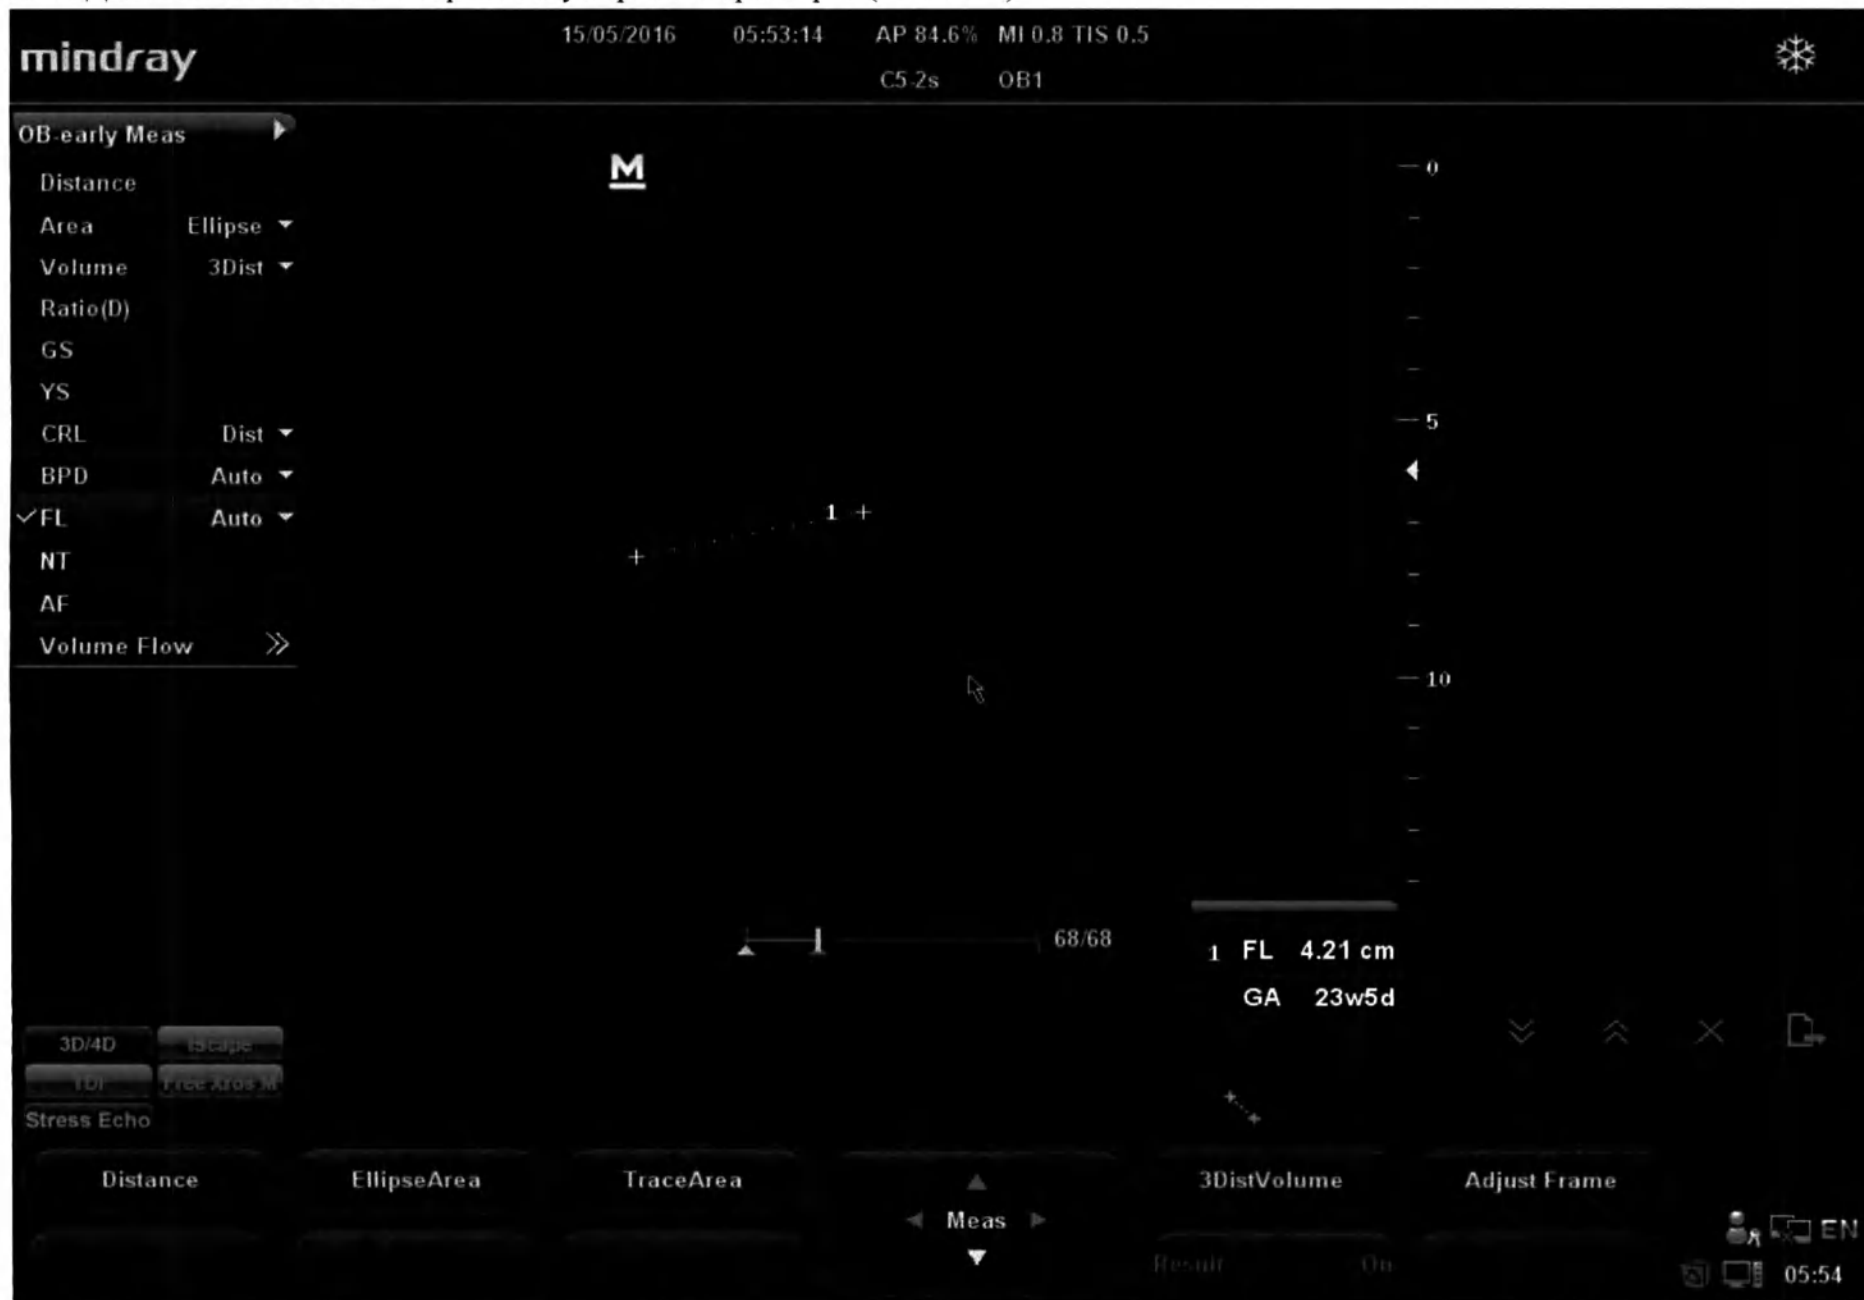


26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)

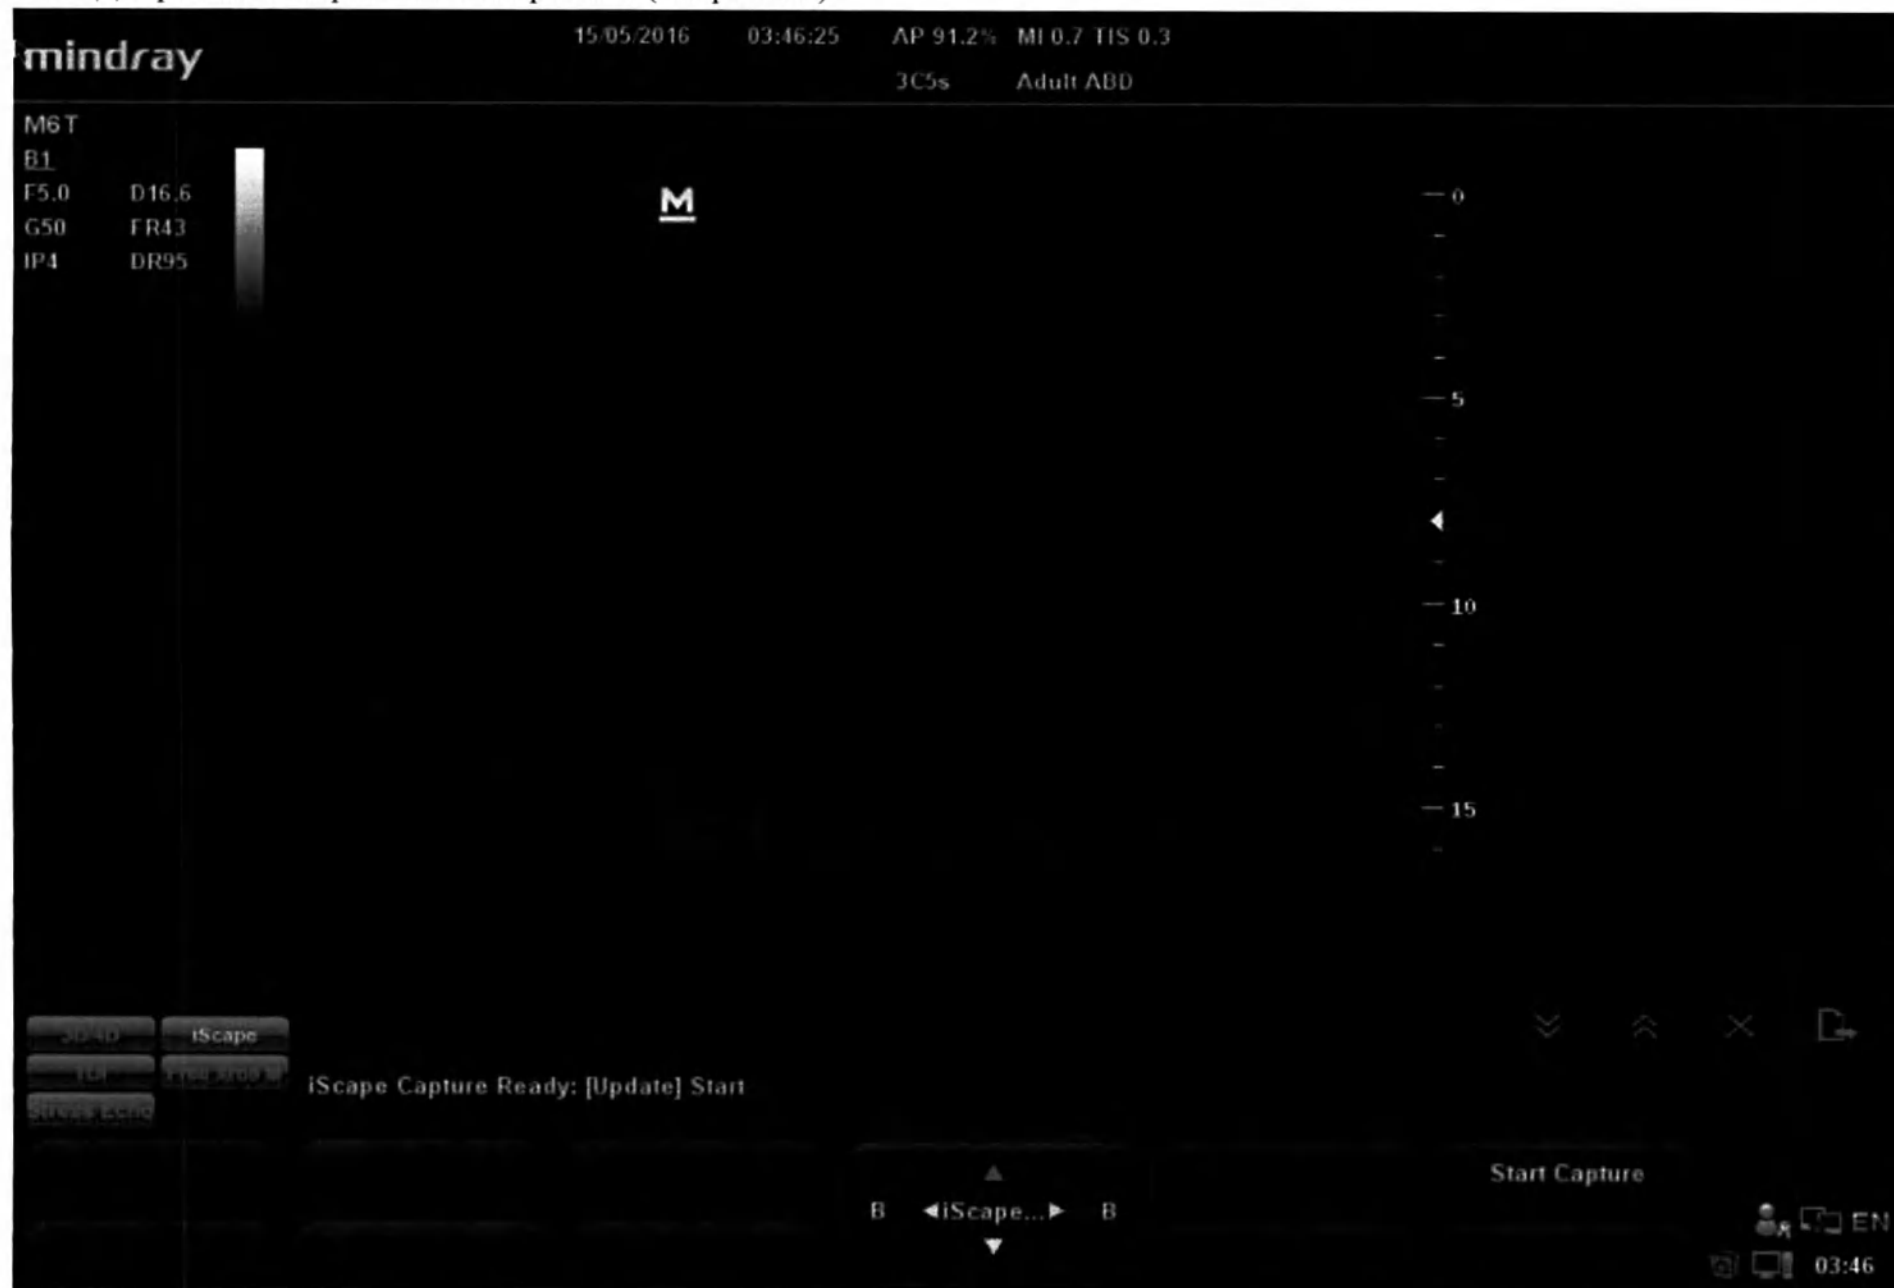


26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)

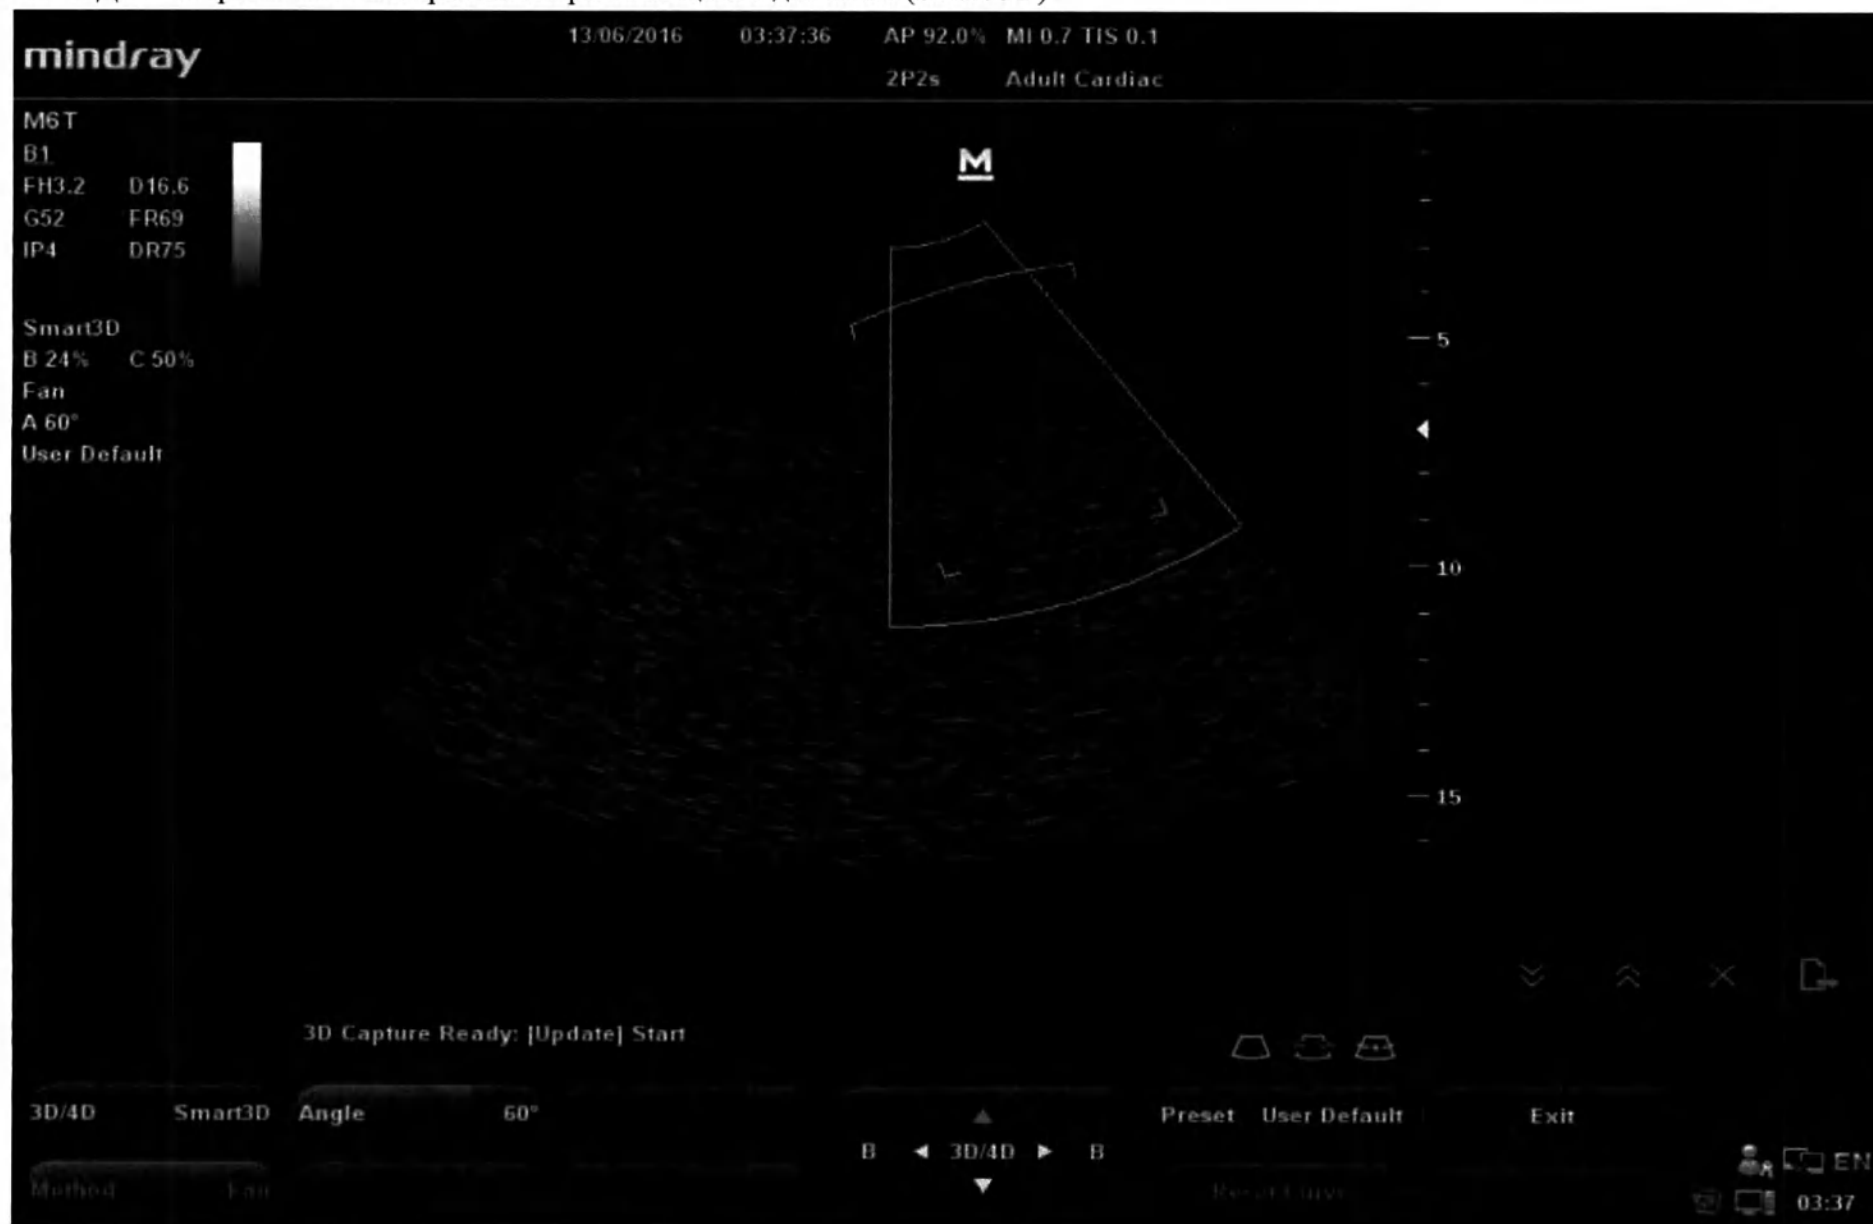


26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)

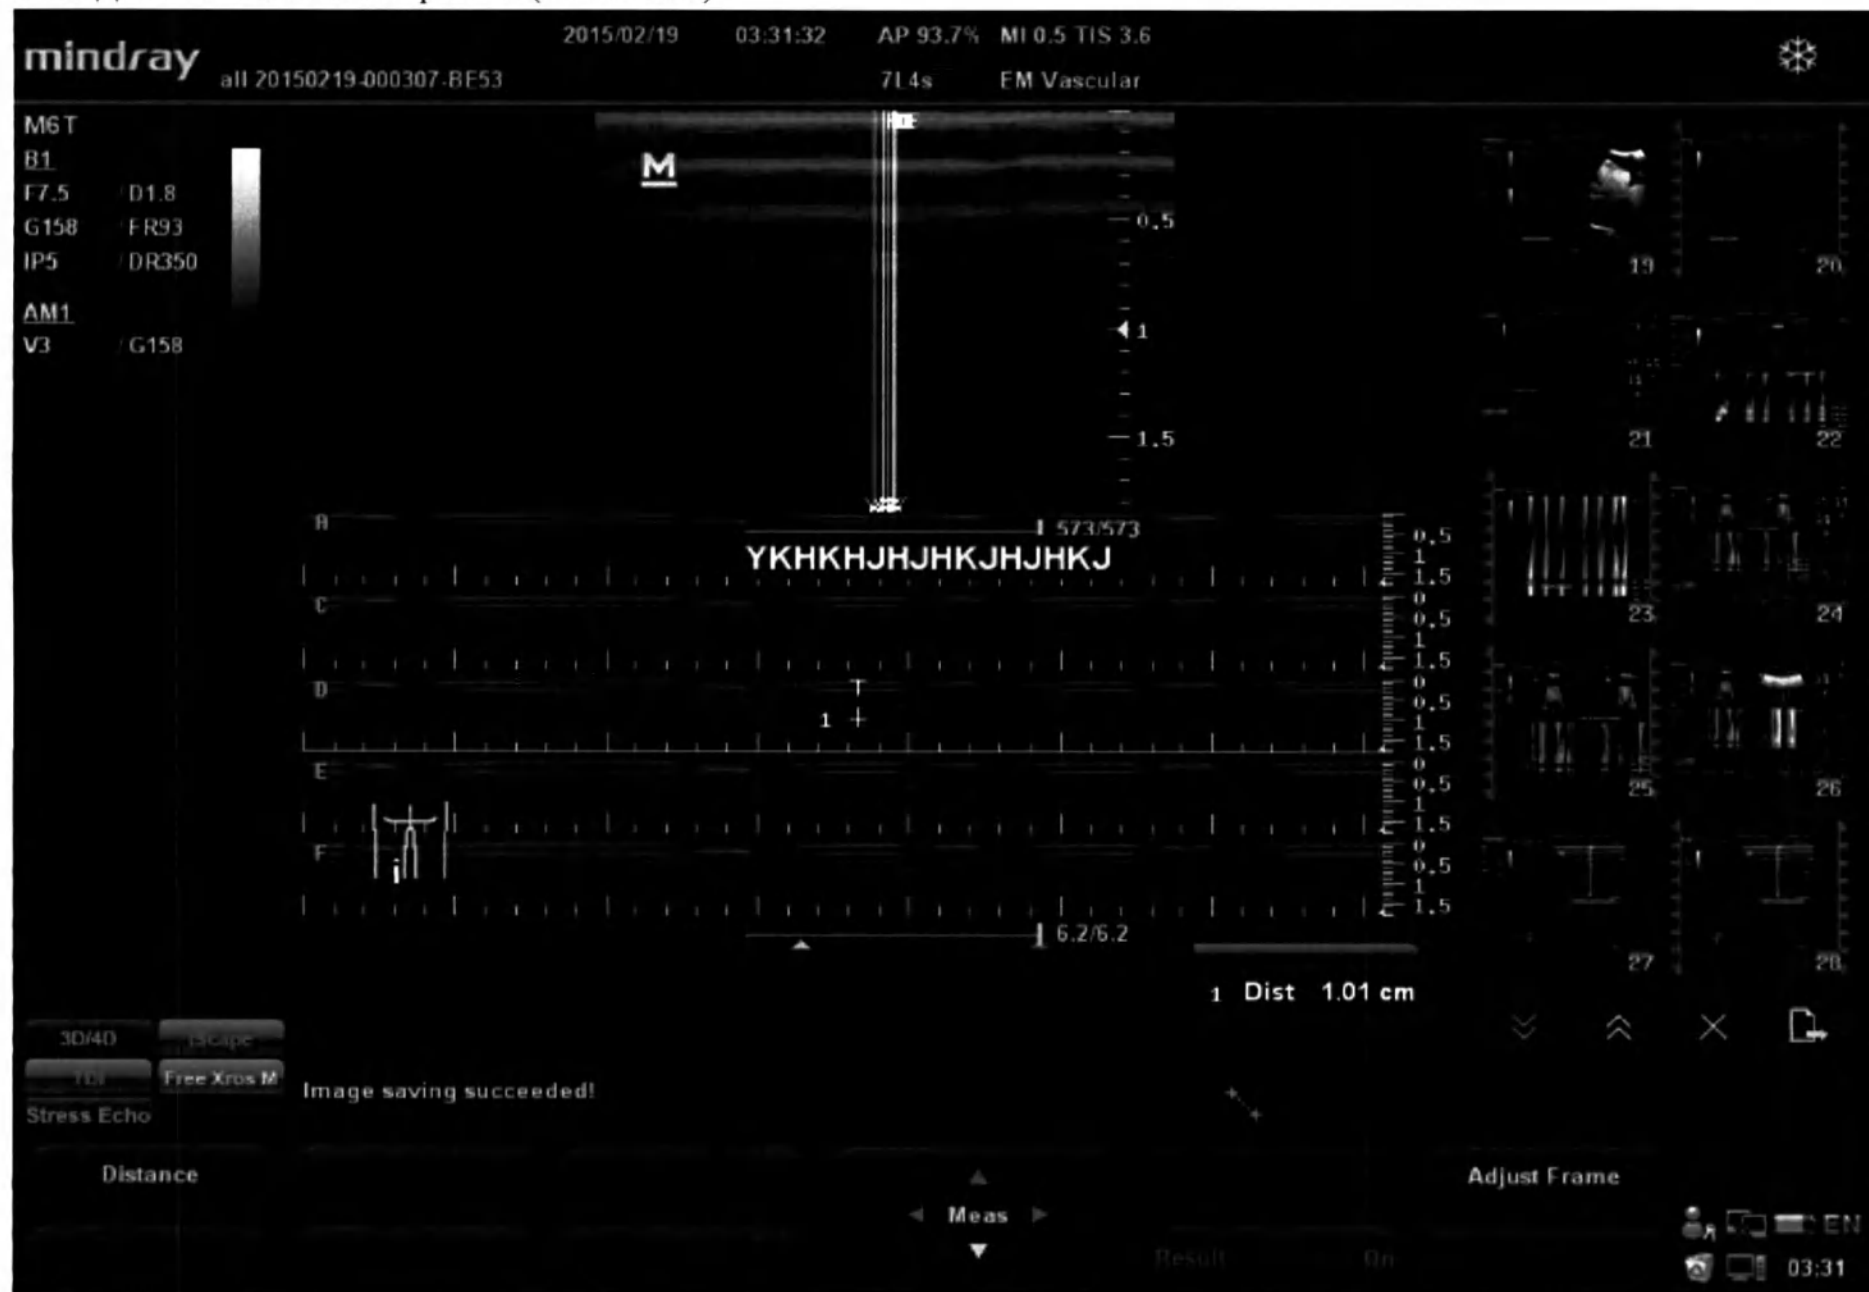

26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)

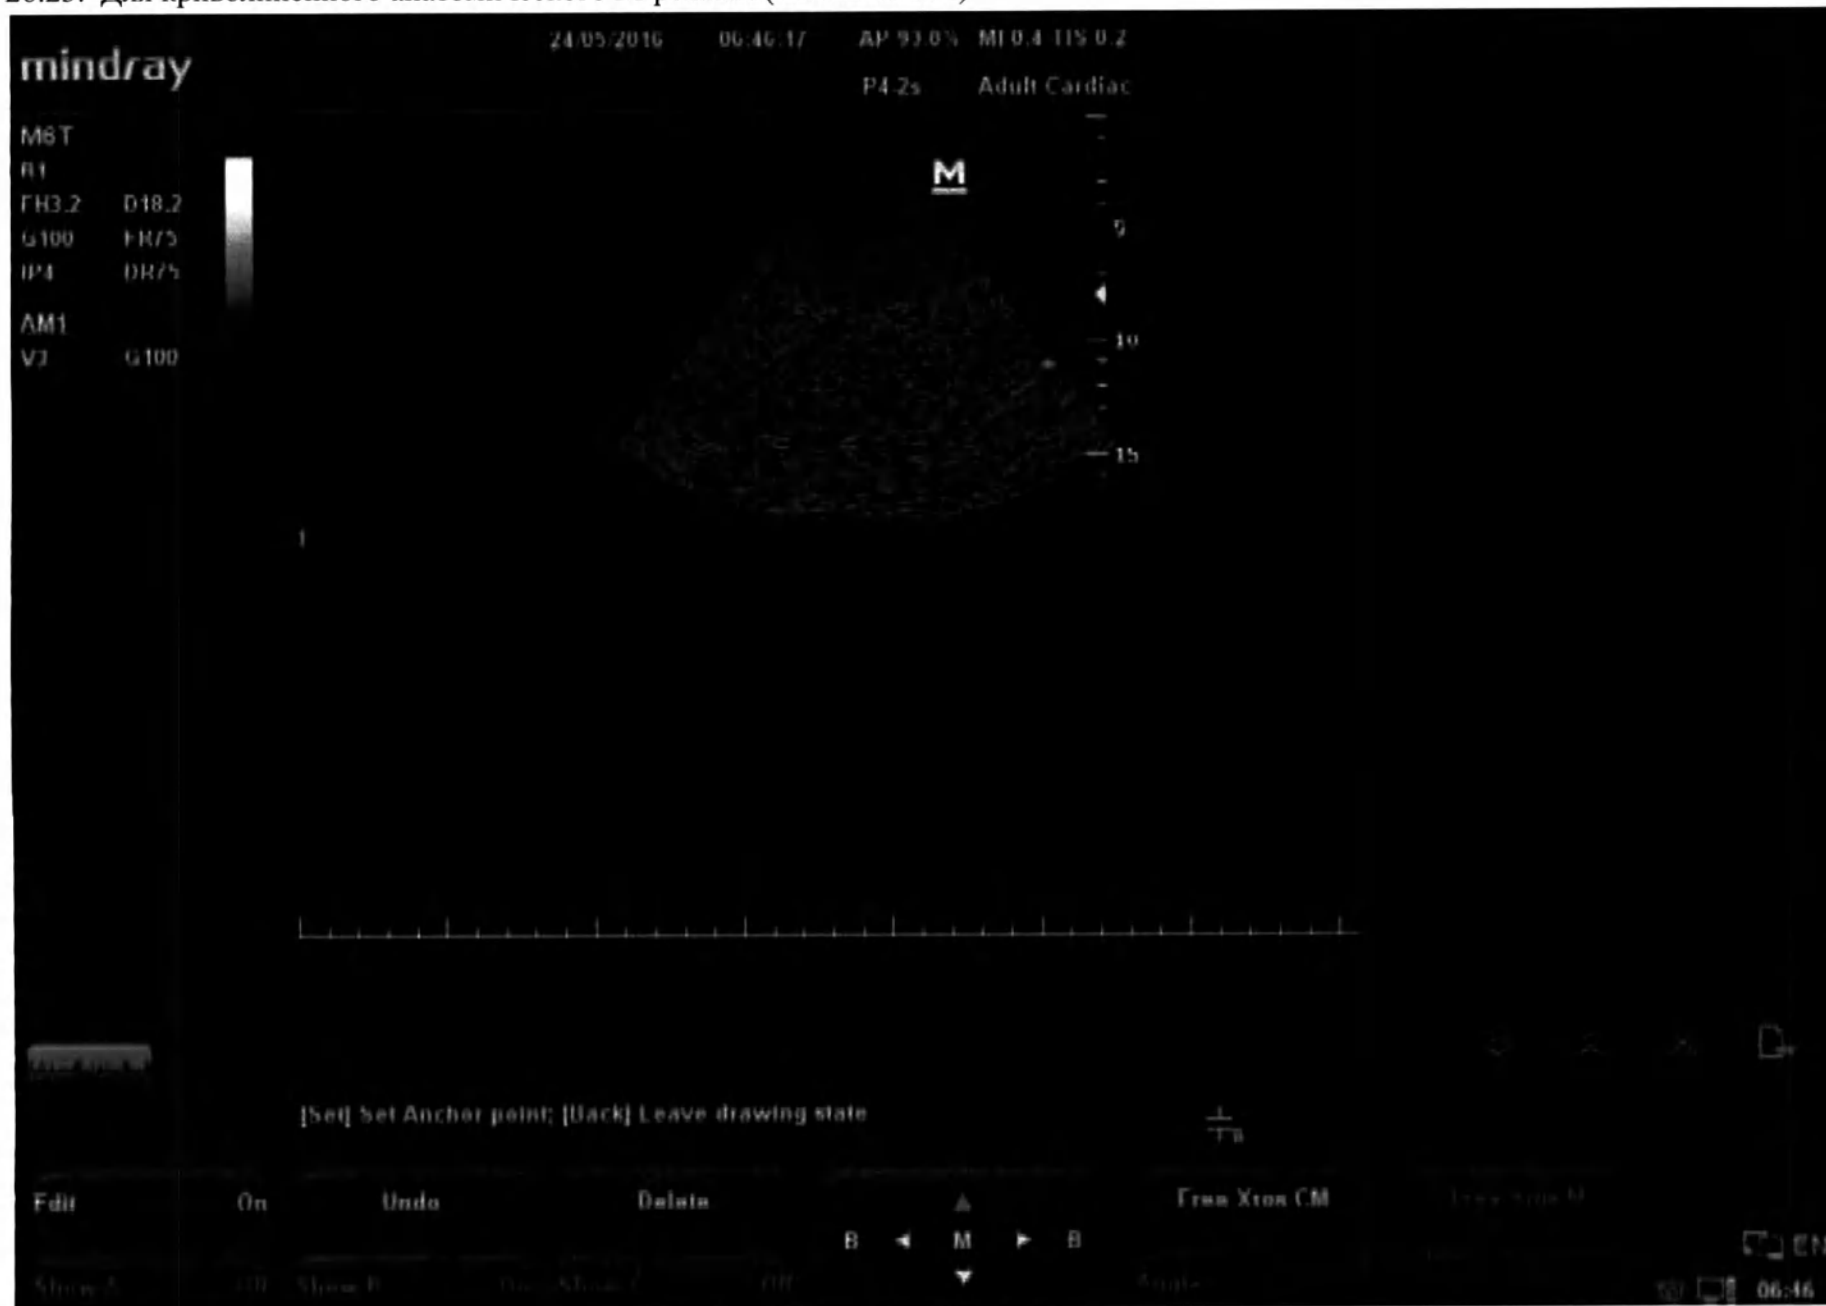

26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)

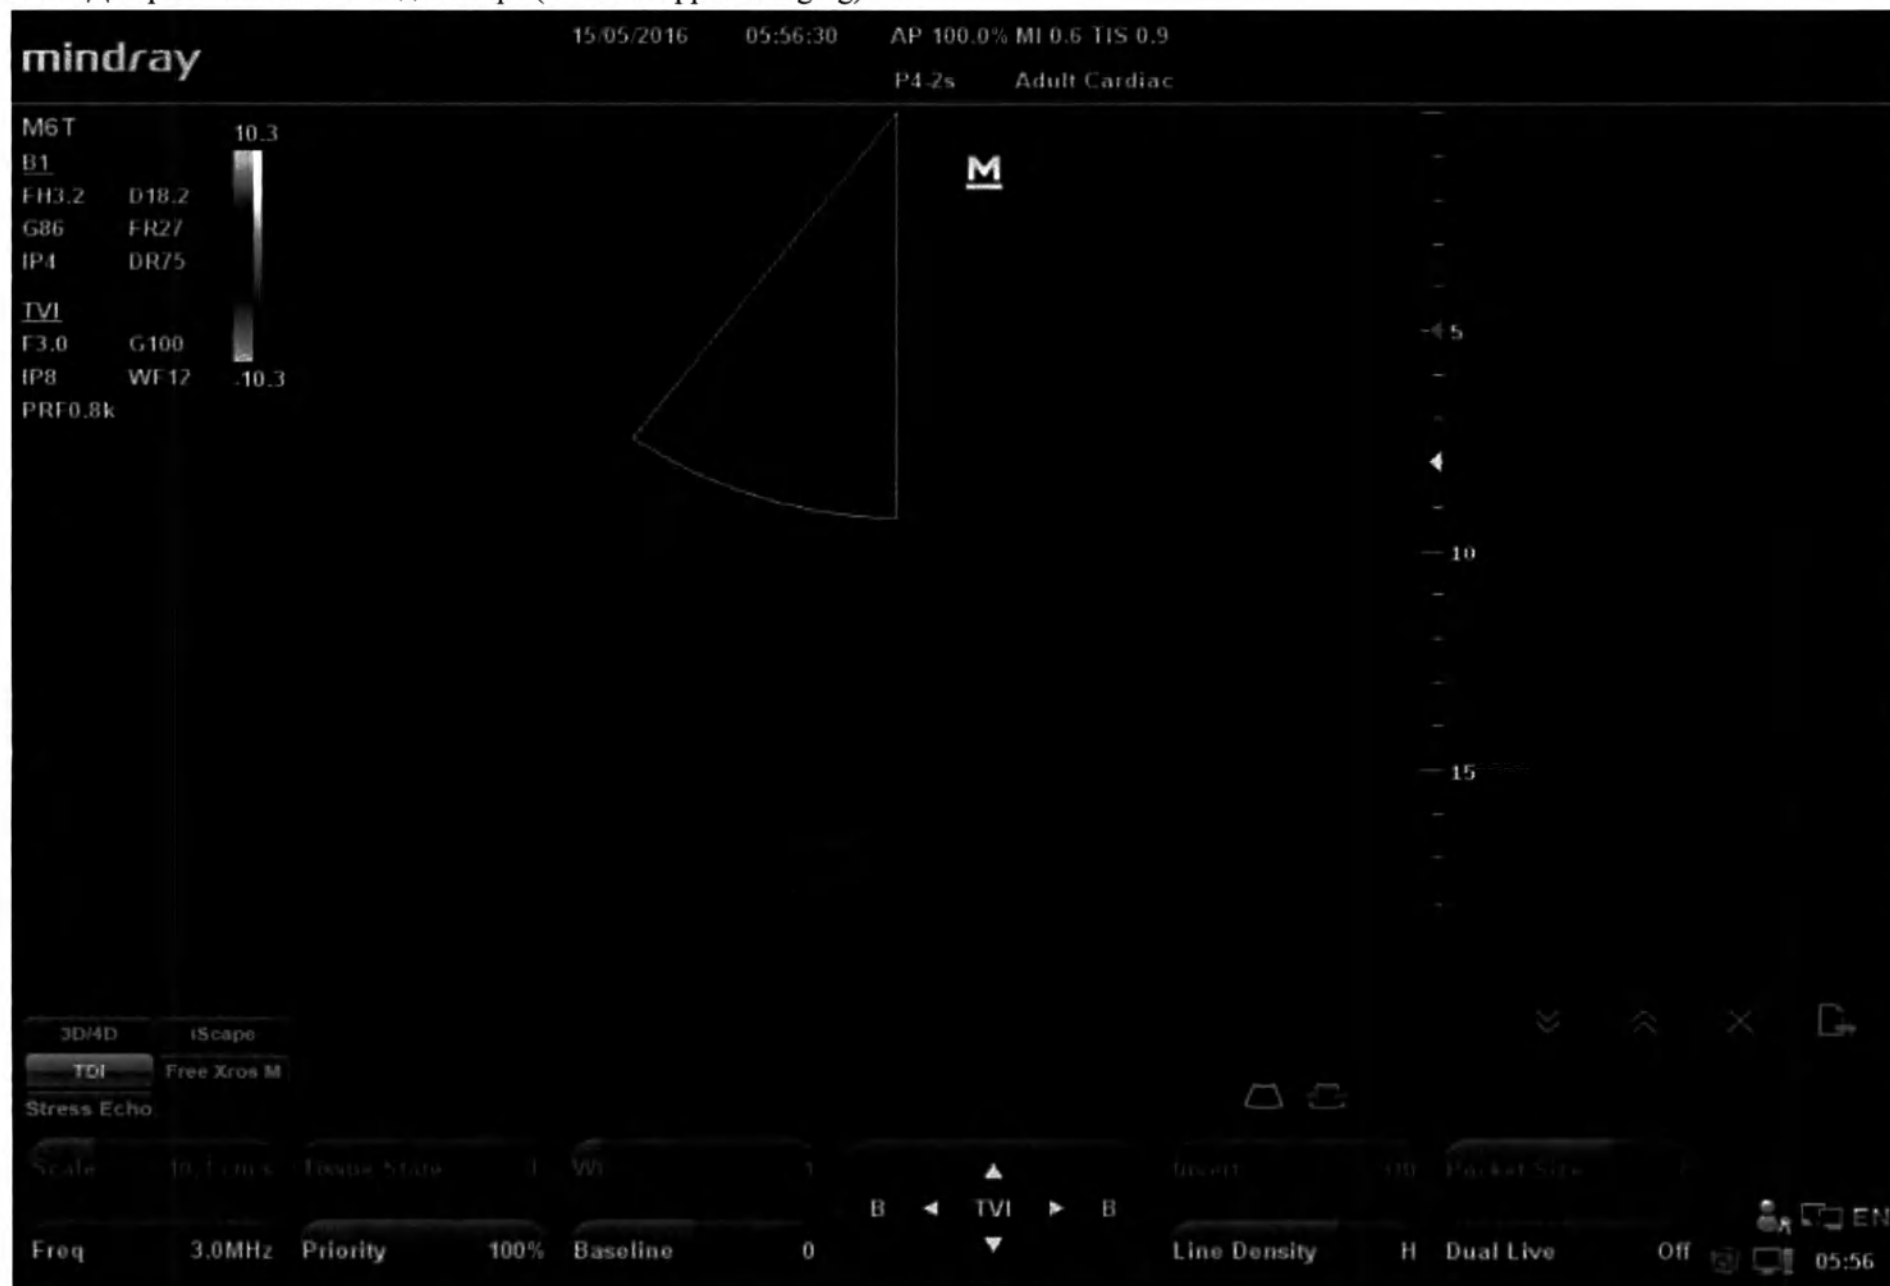

26.25. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)





26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)



26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)




26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)



26.30. Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT)




26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

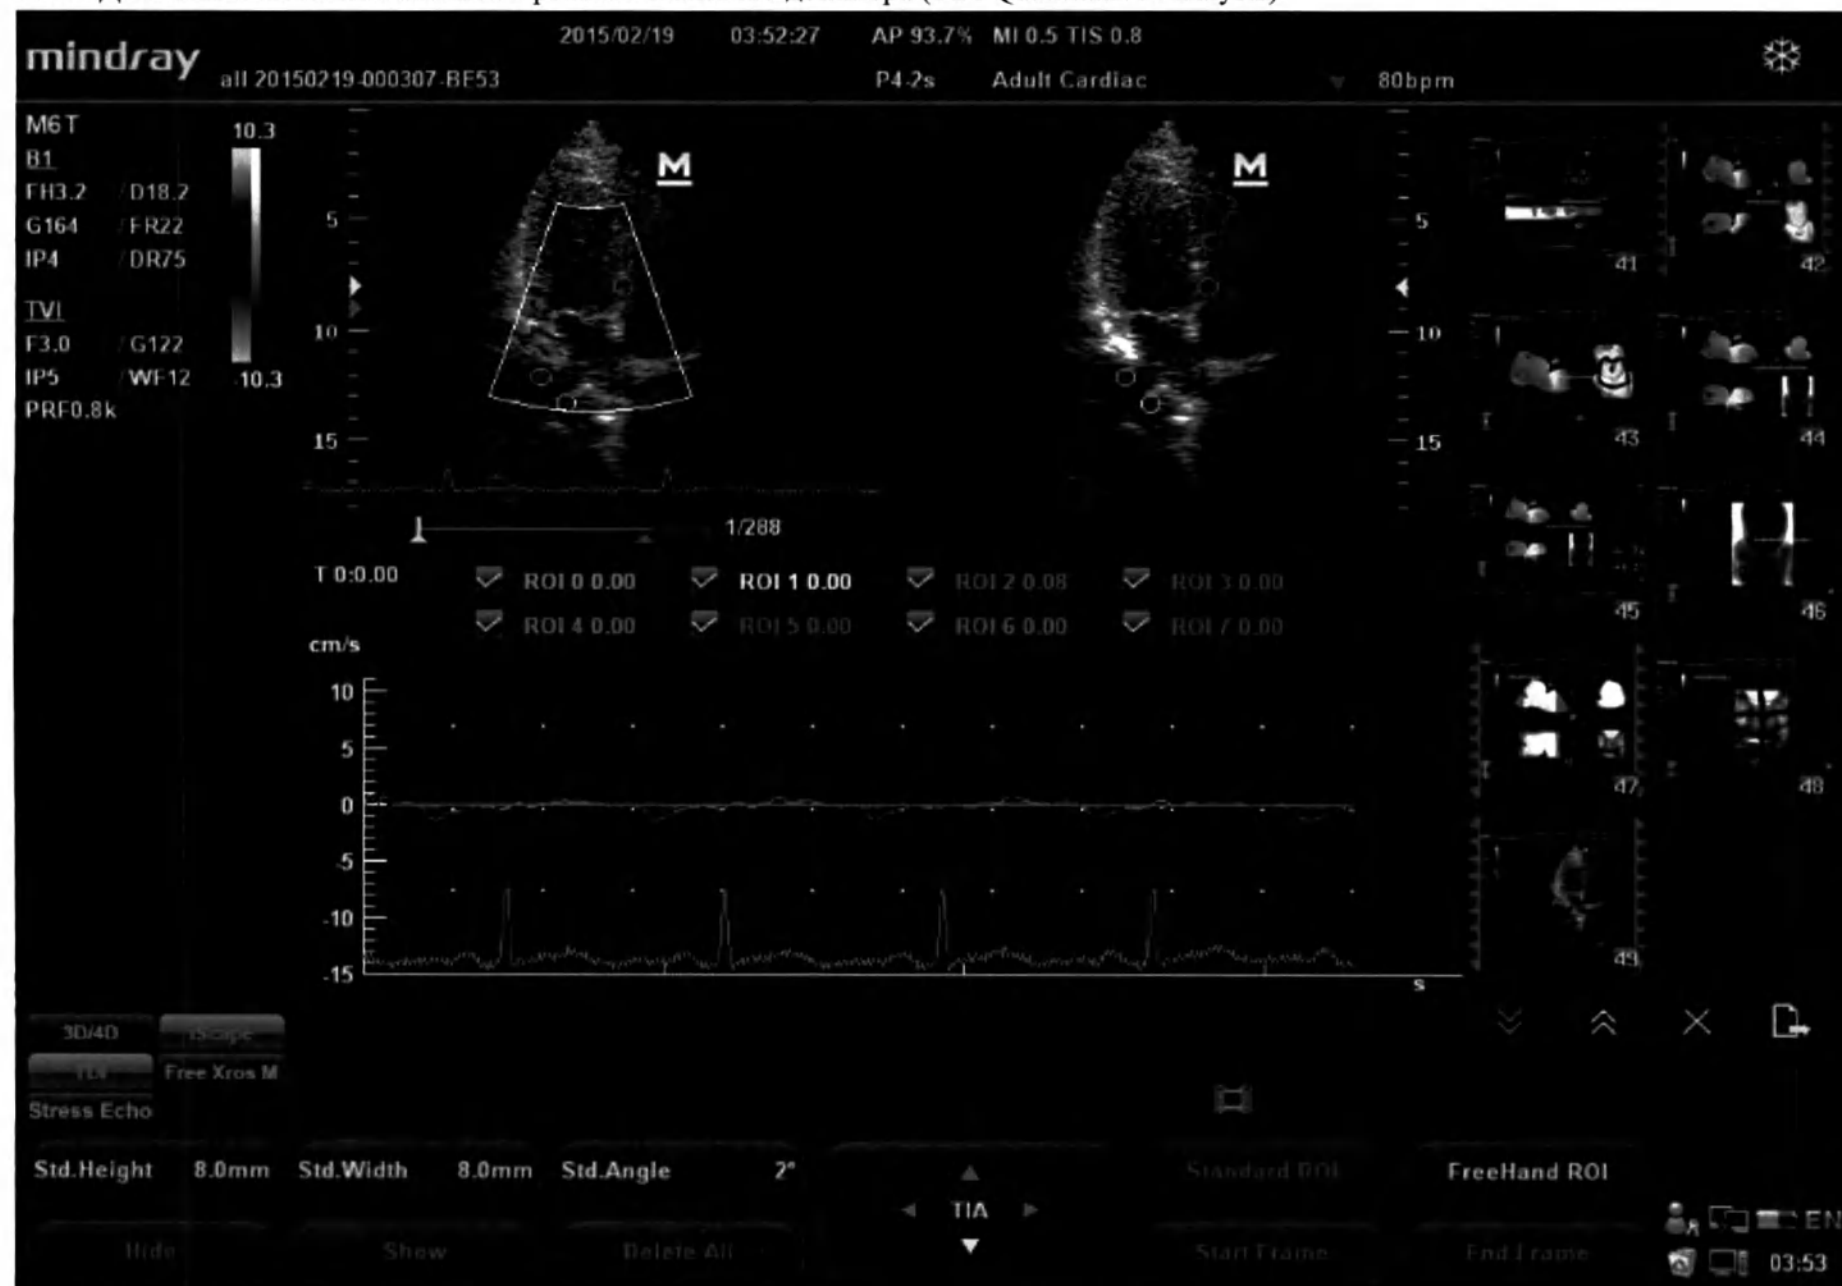



27. Модули:

27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

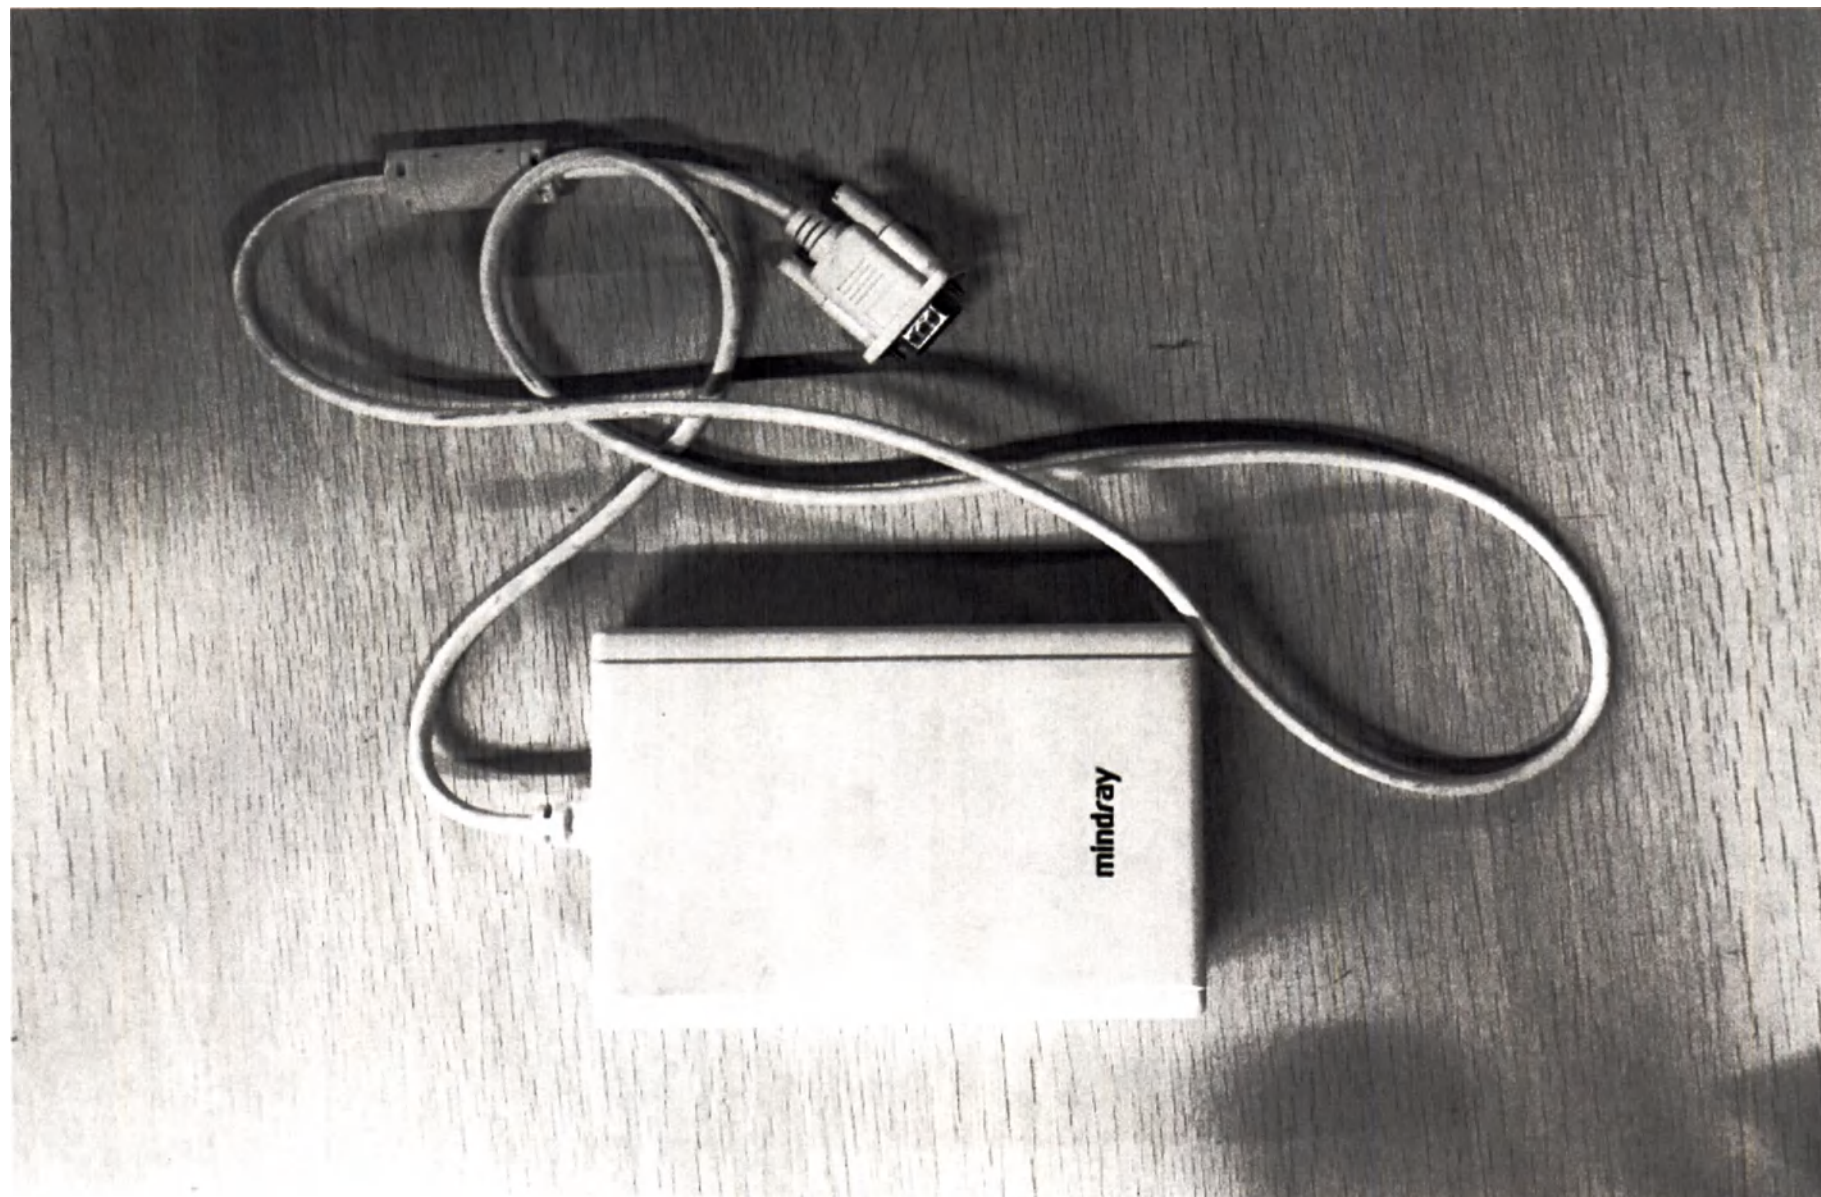




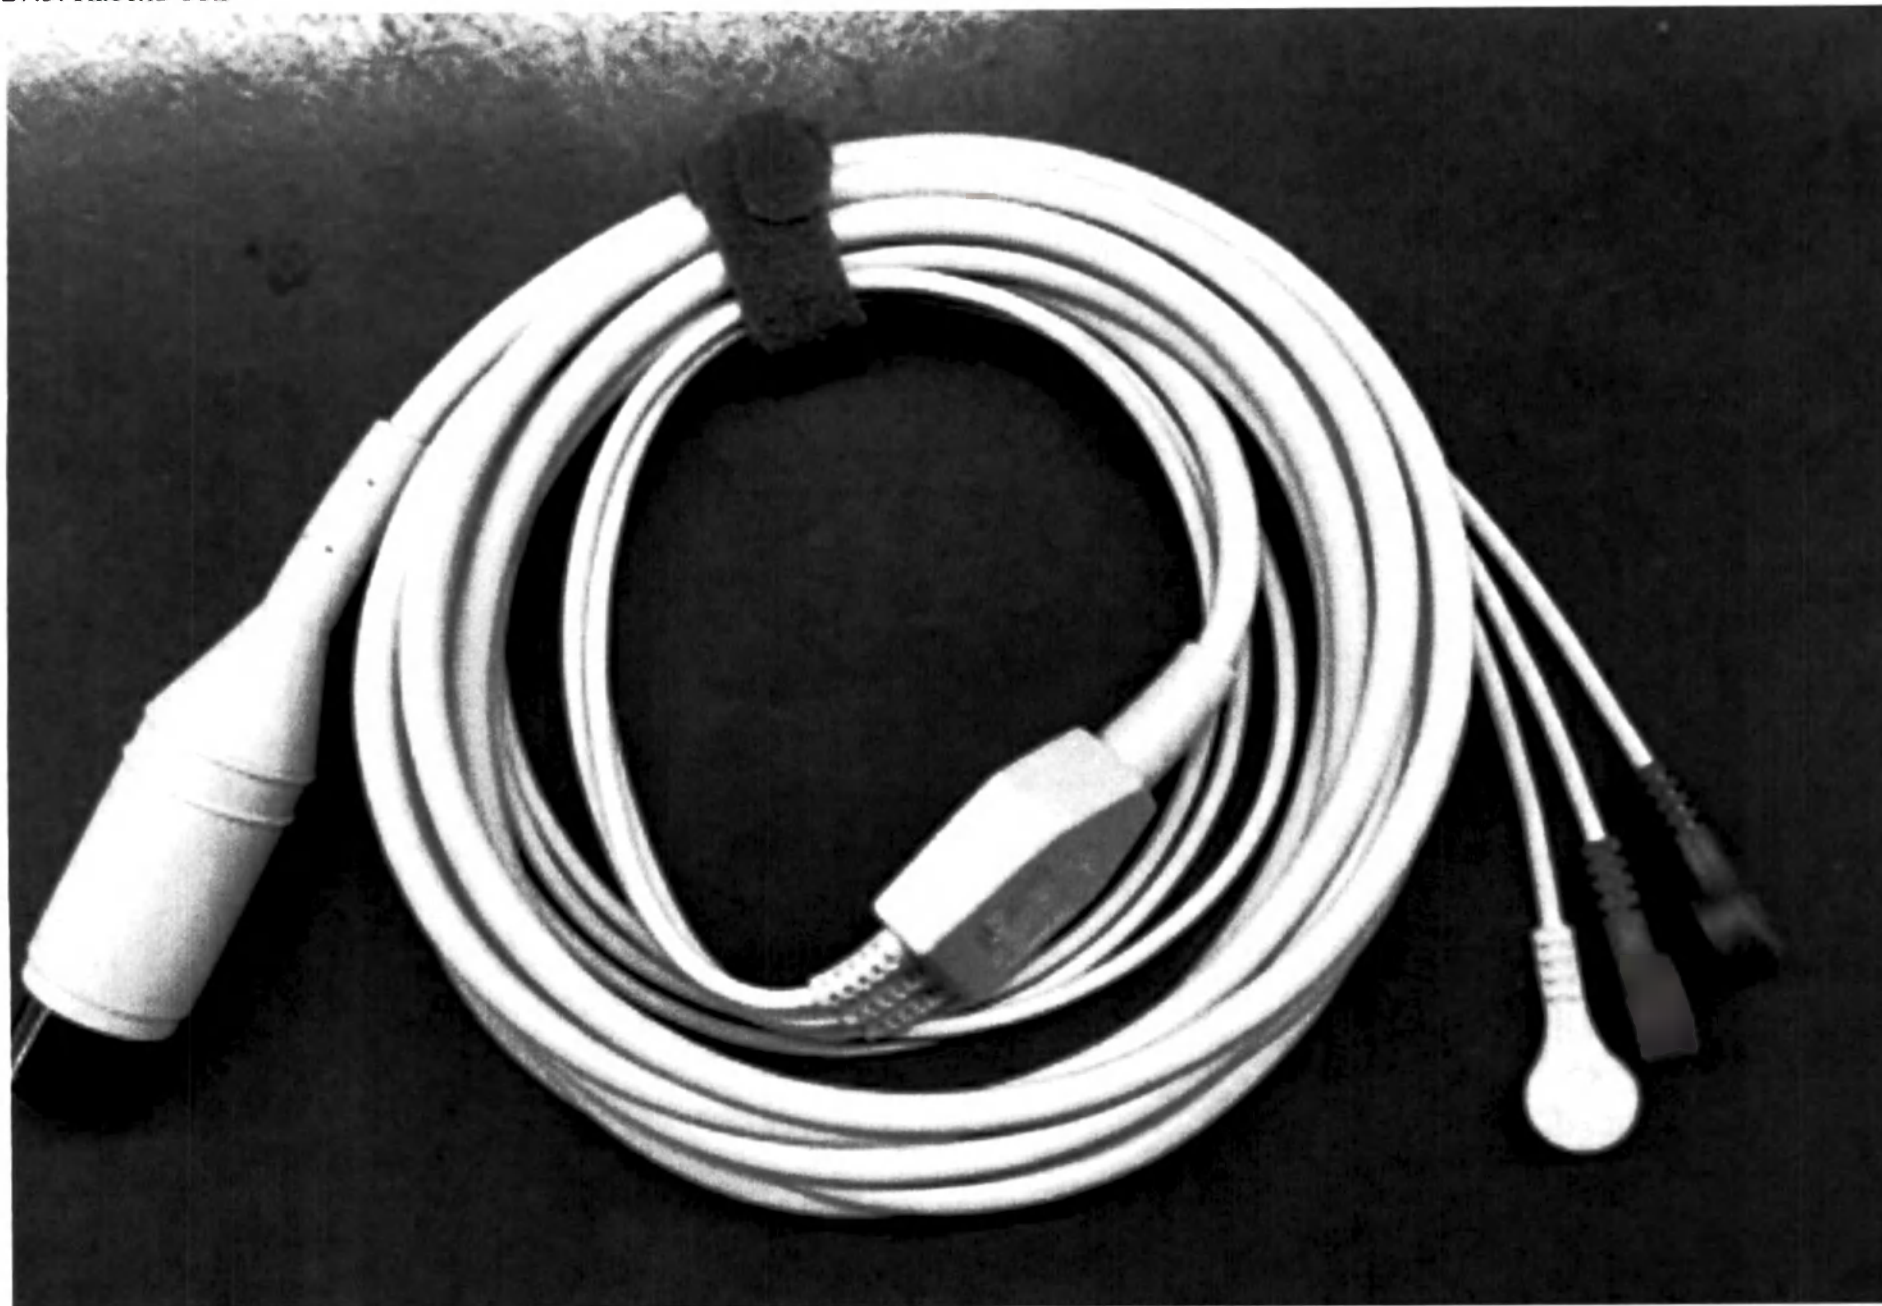


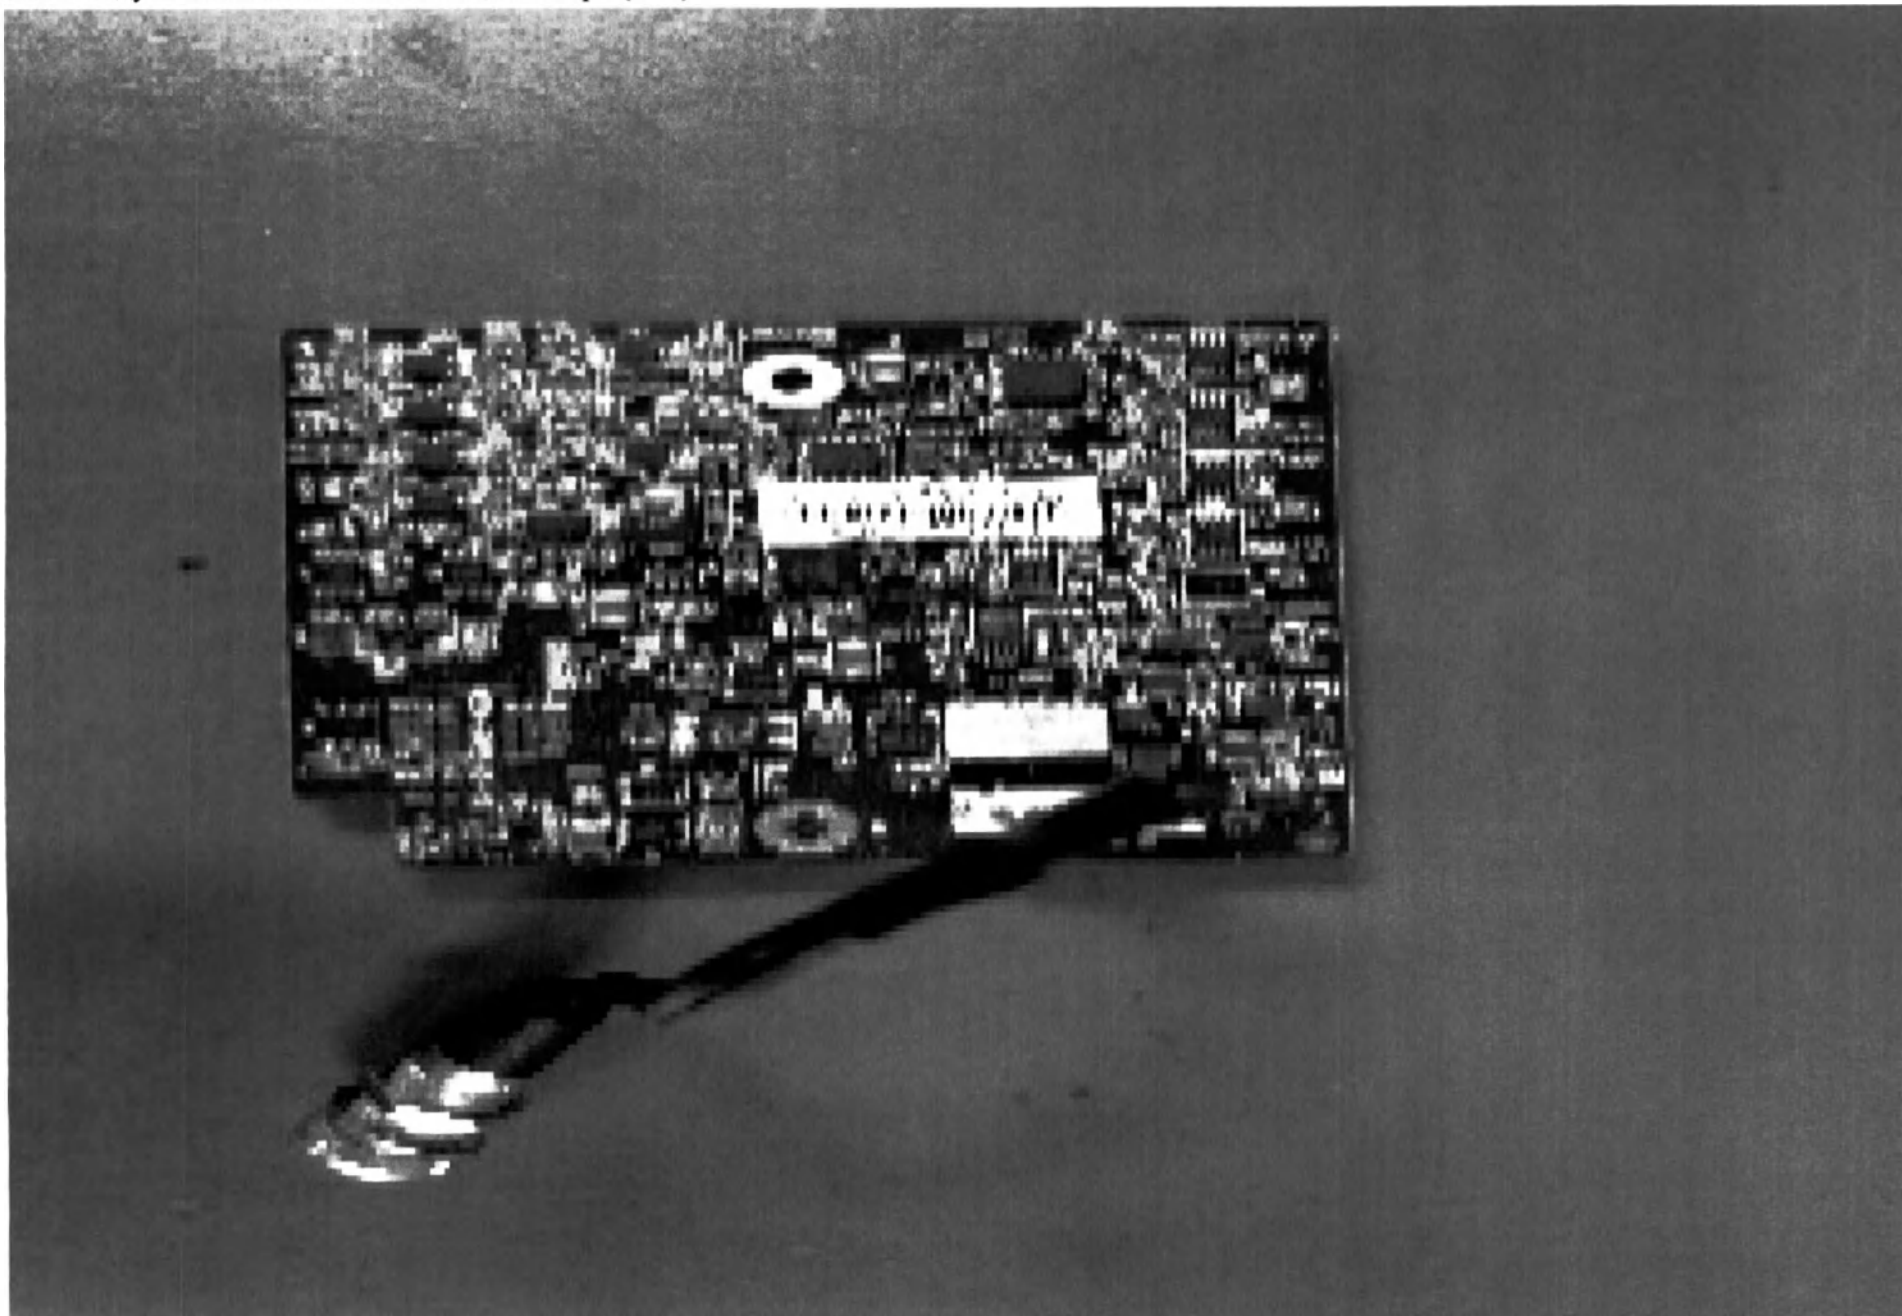



28. Тележки

28. 1 . Тележка мобильная UMT-300

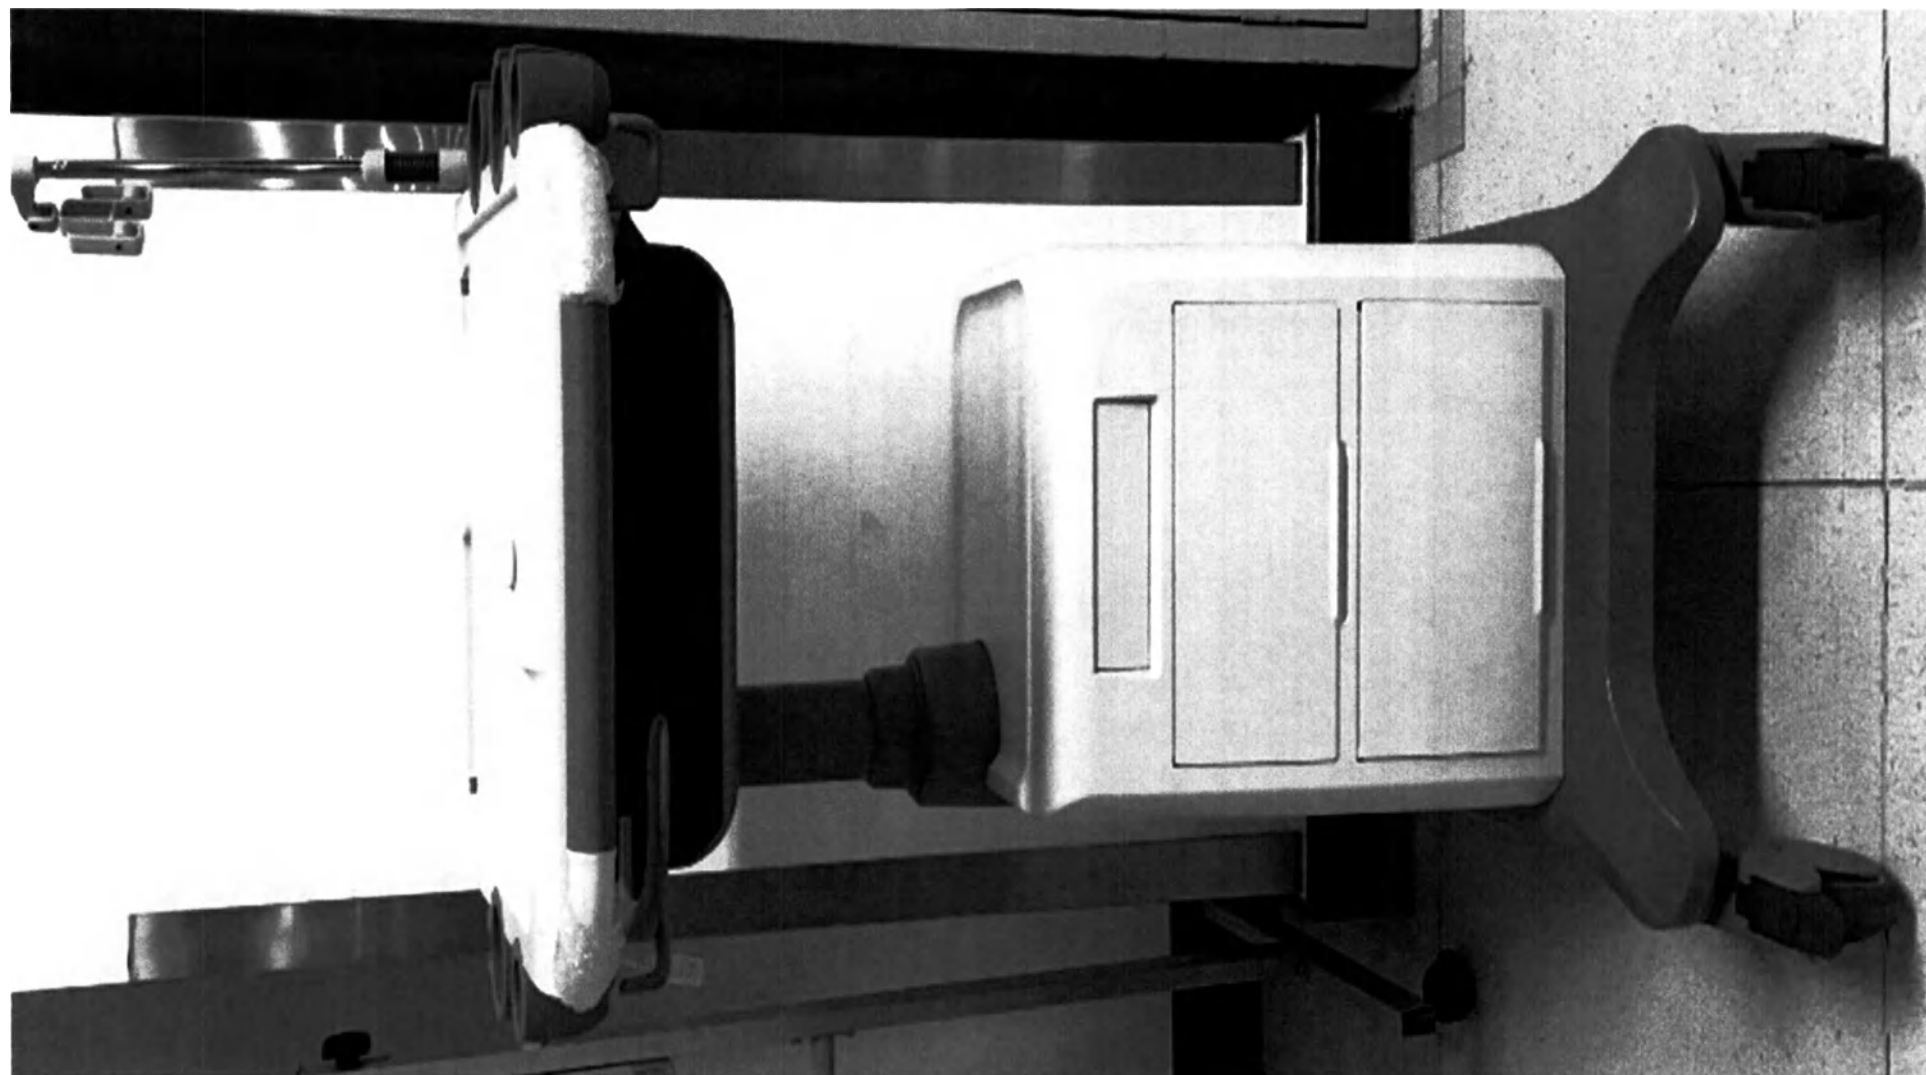

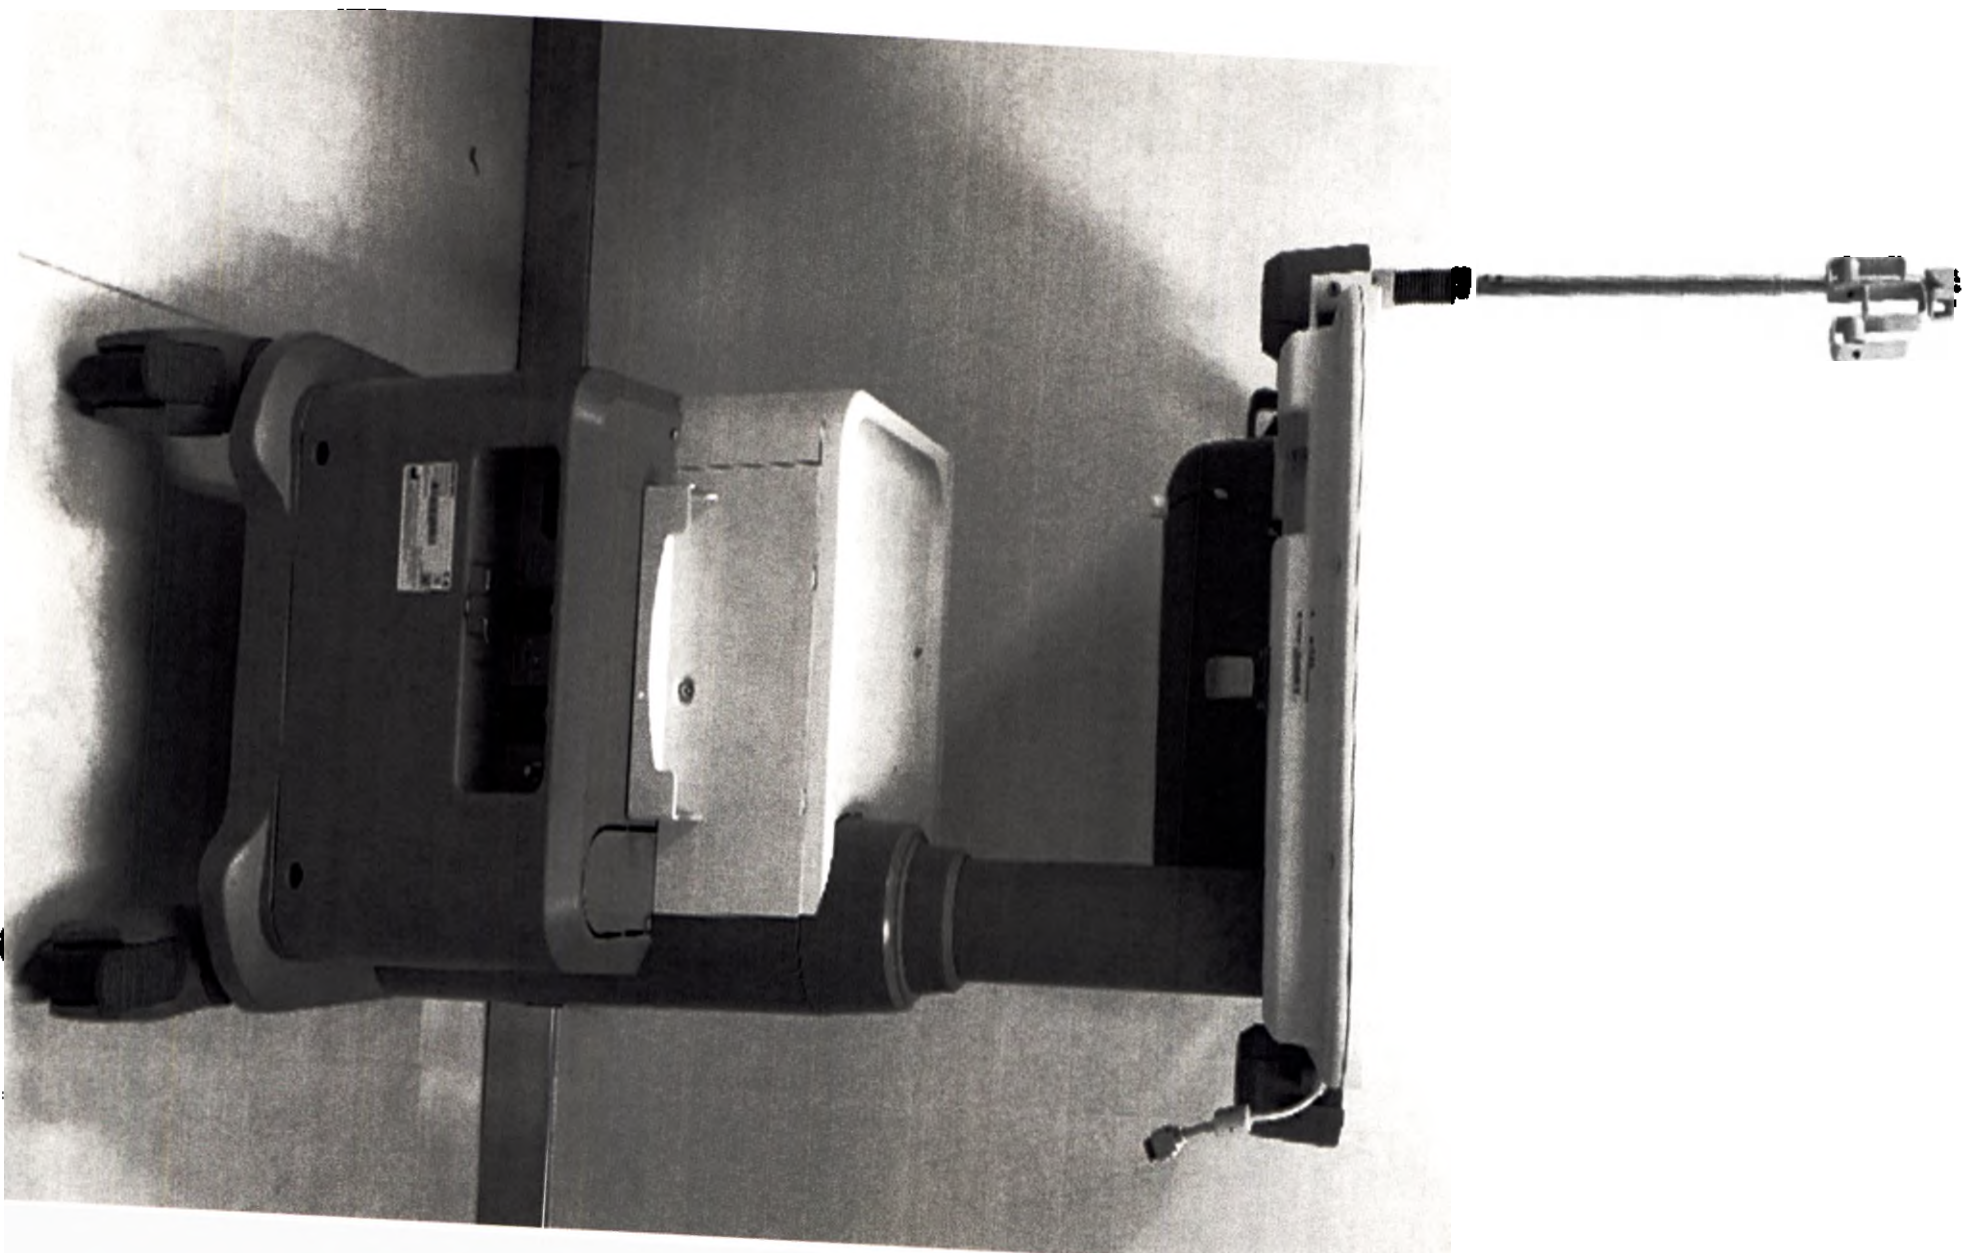


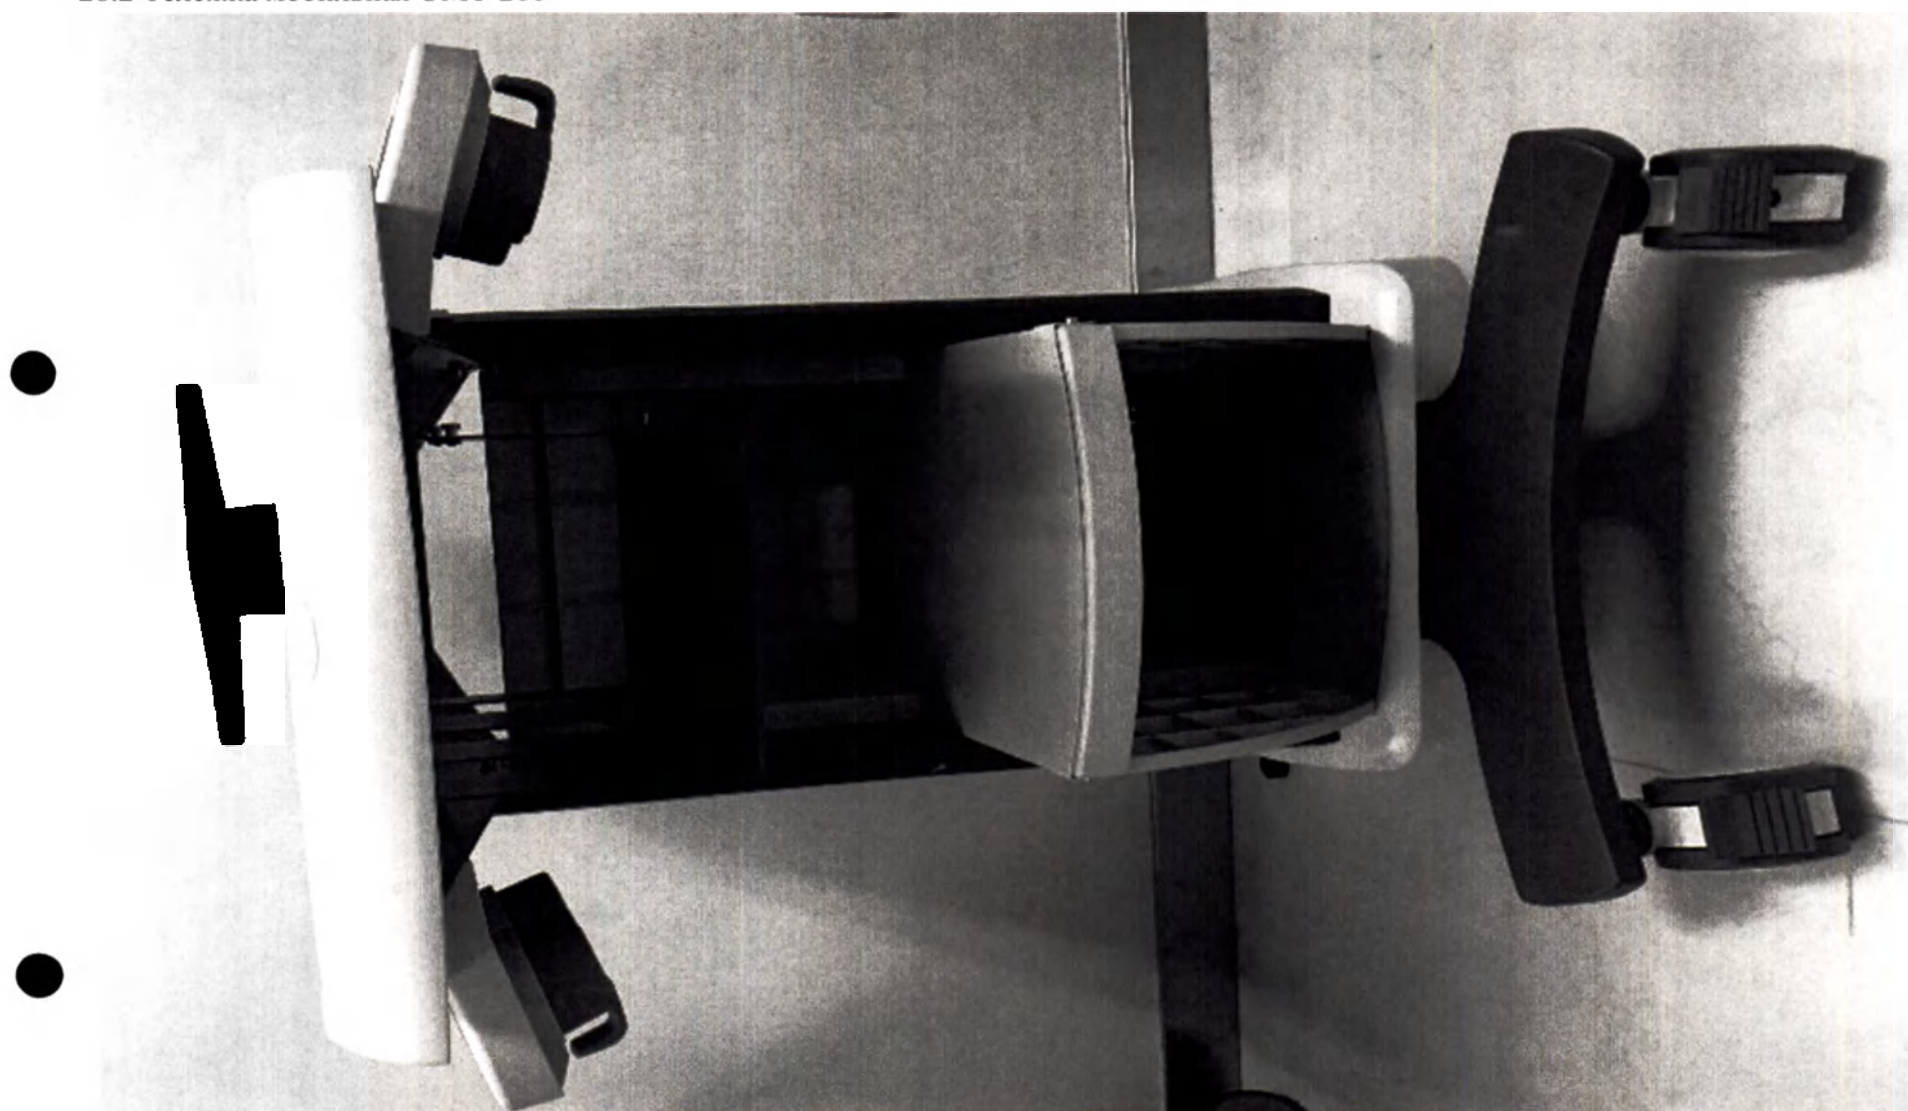

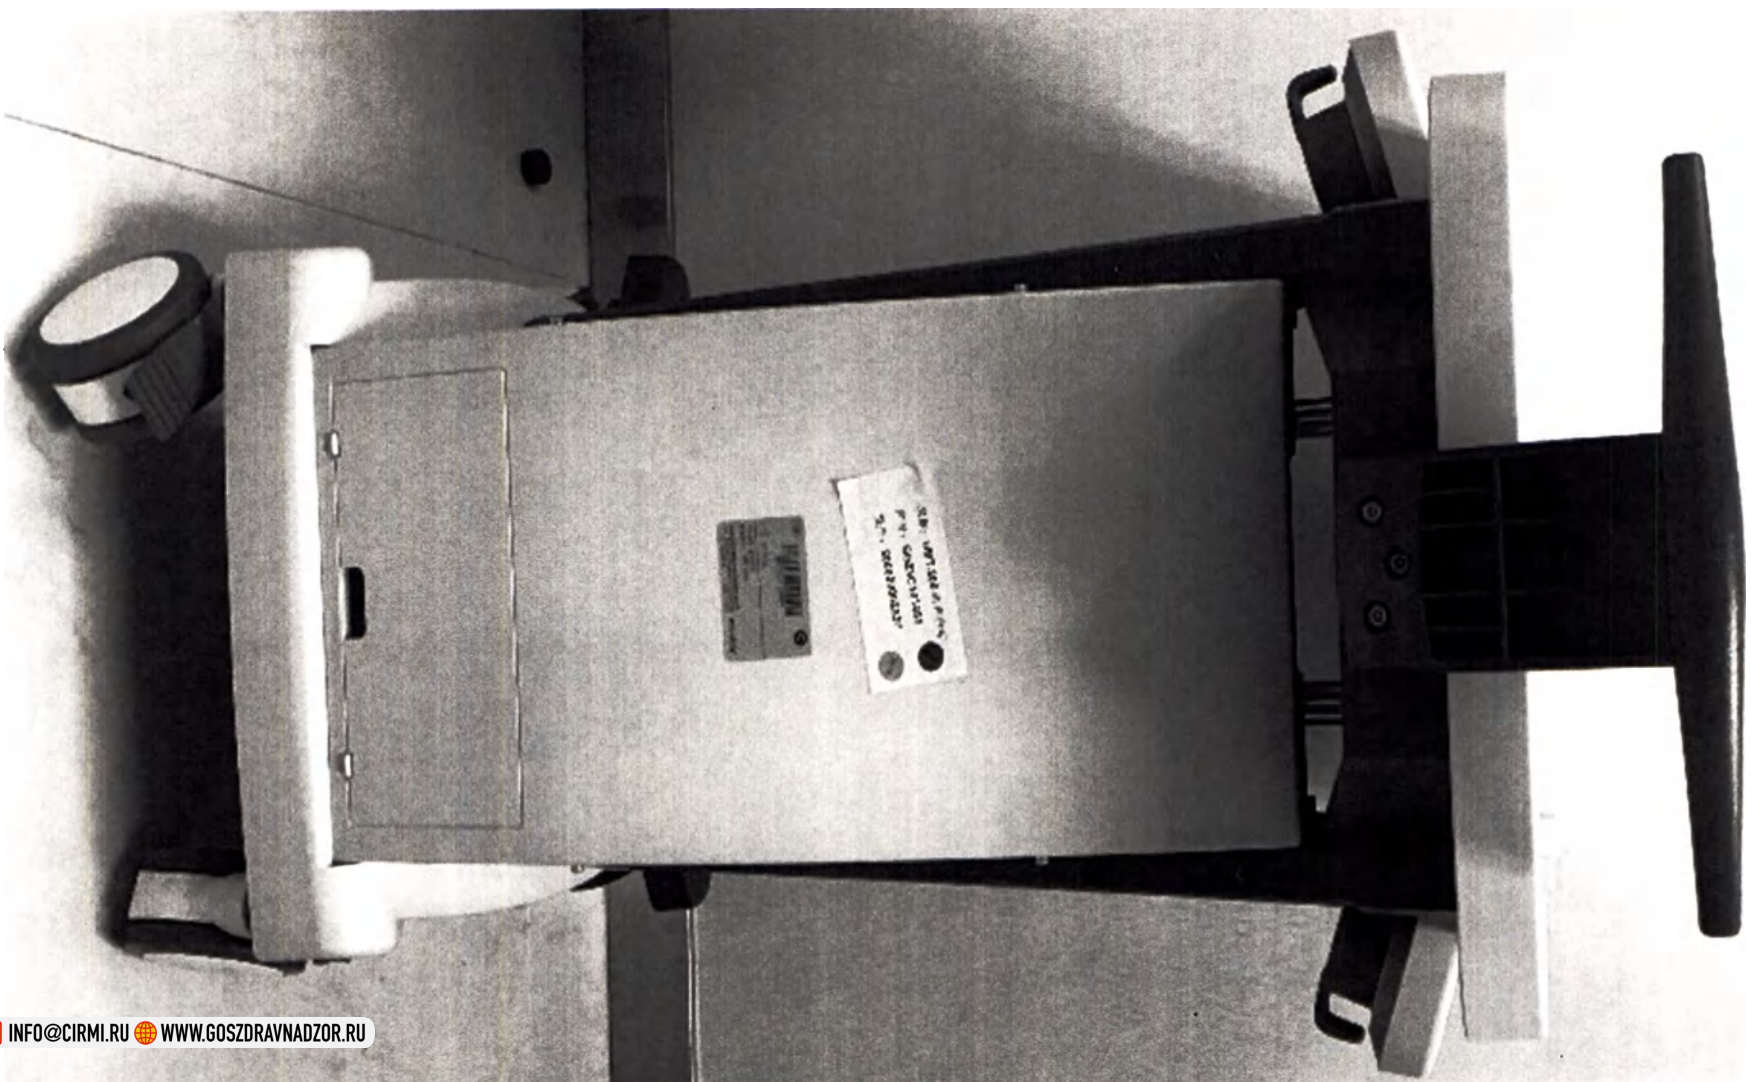


Принадлежности:


1. Ножной переключатель, 2 клавиши

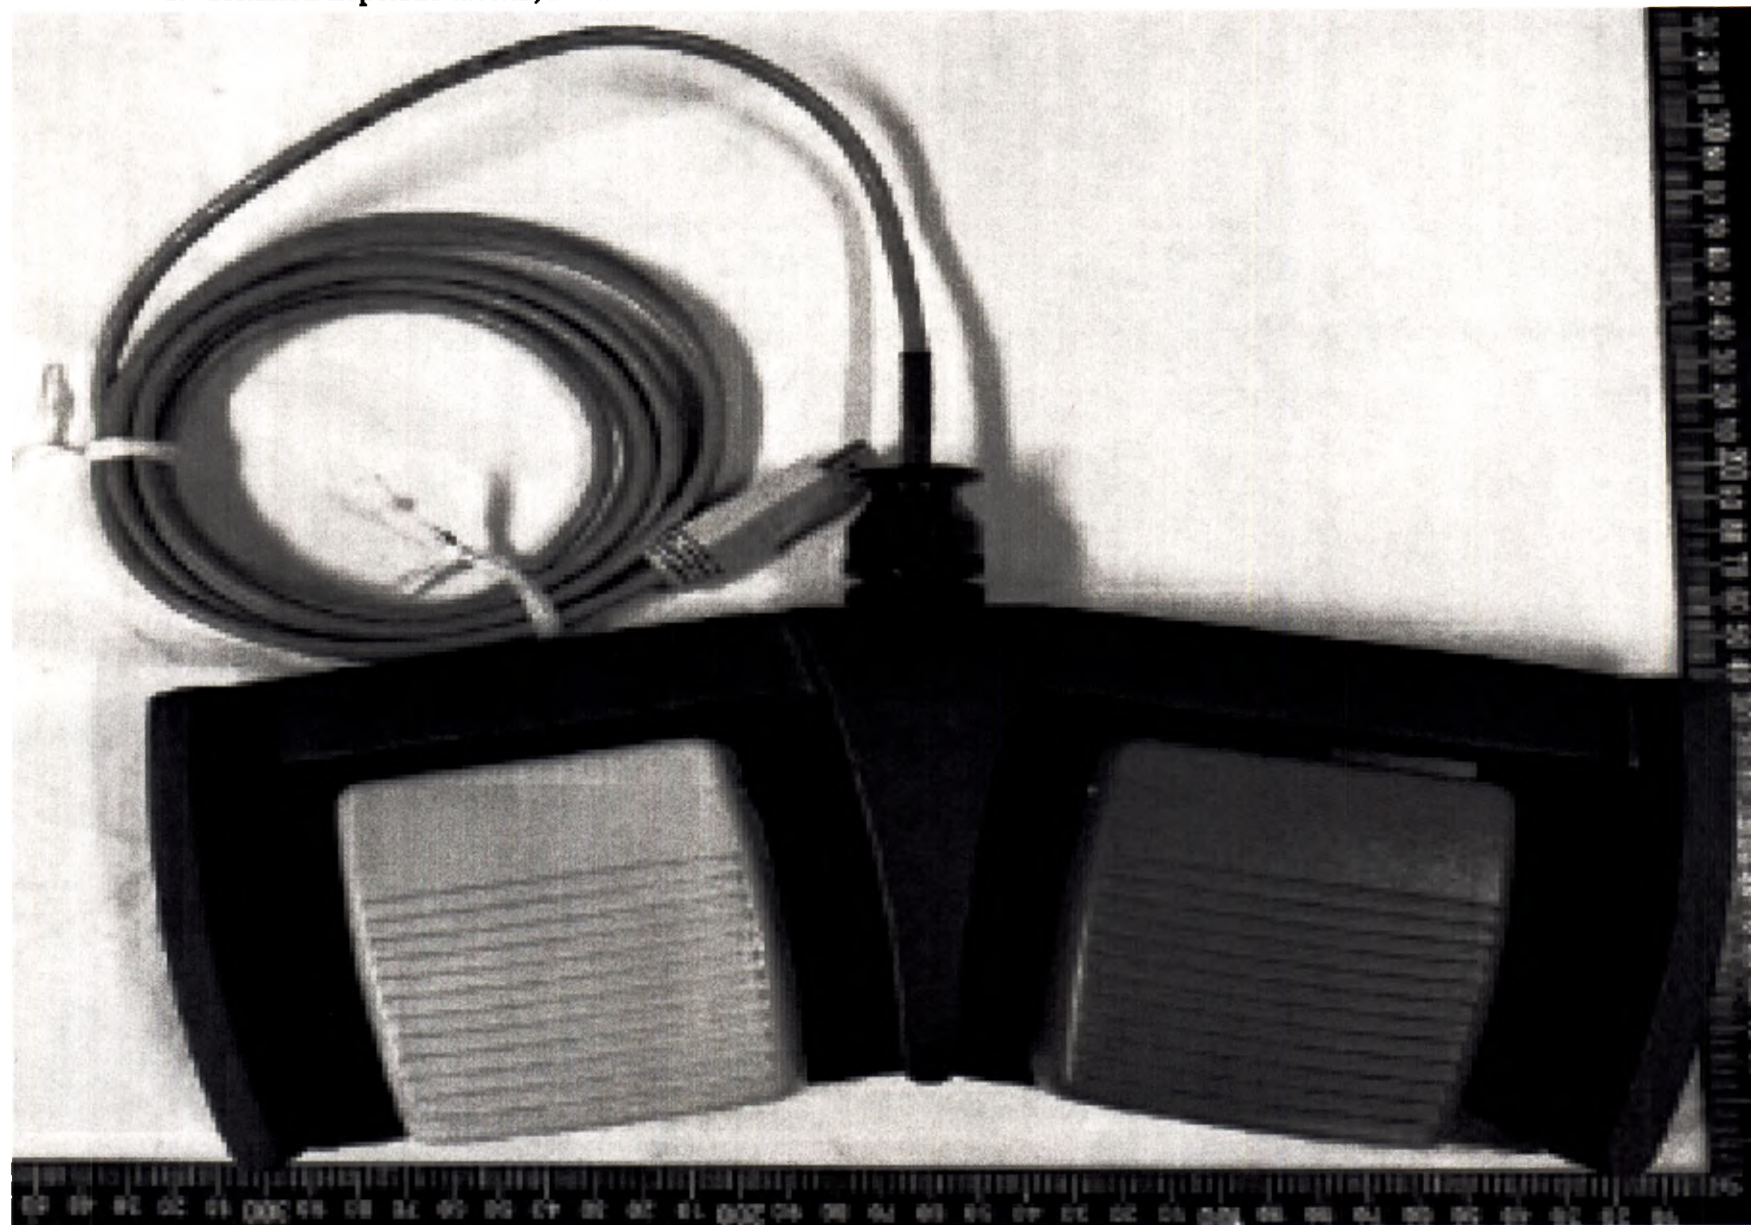


2.Ножной переключатель, 3 клавиши

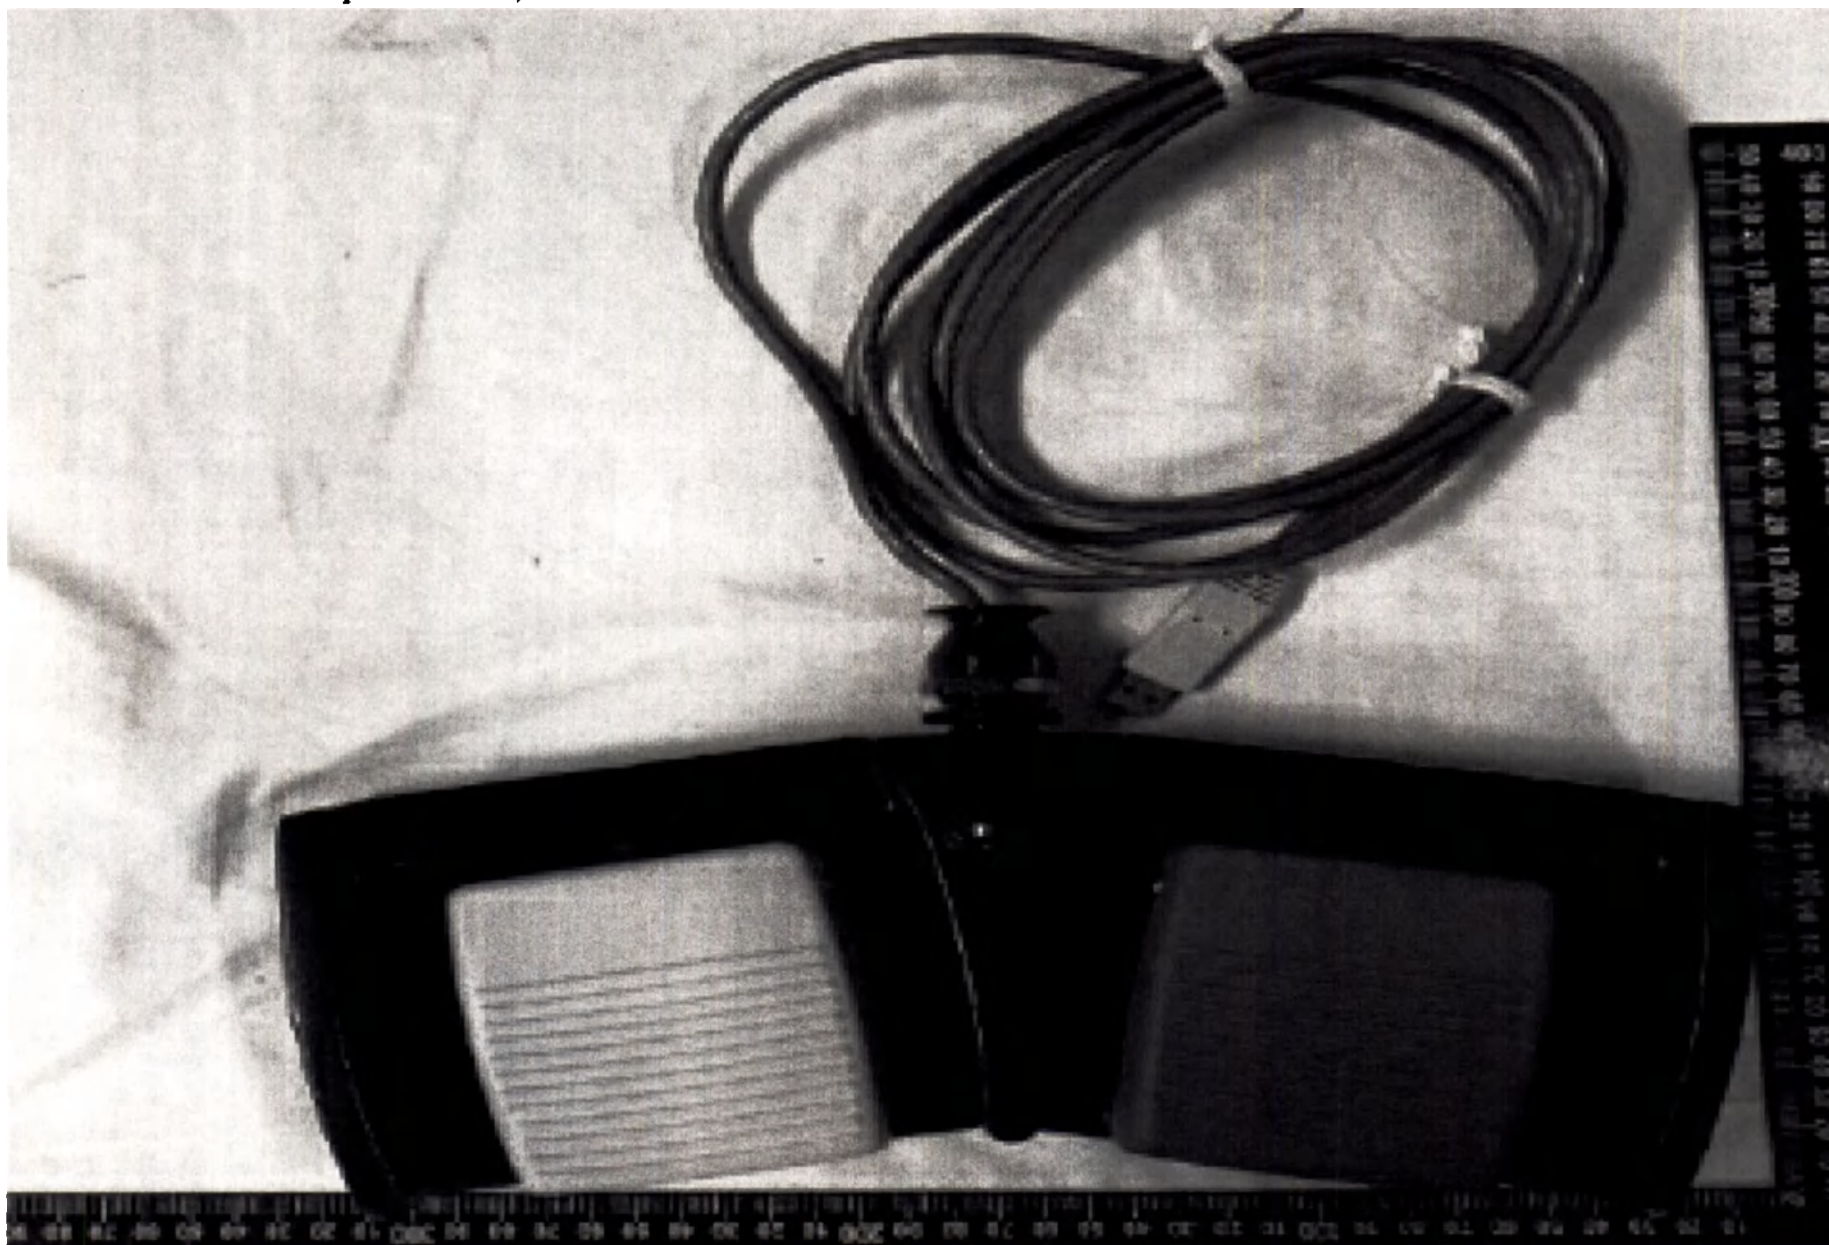

VI. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, вариант исполнения М6s, в составе:
1. Основной блок М6s

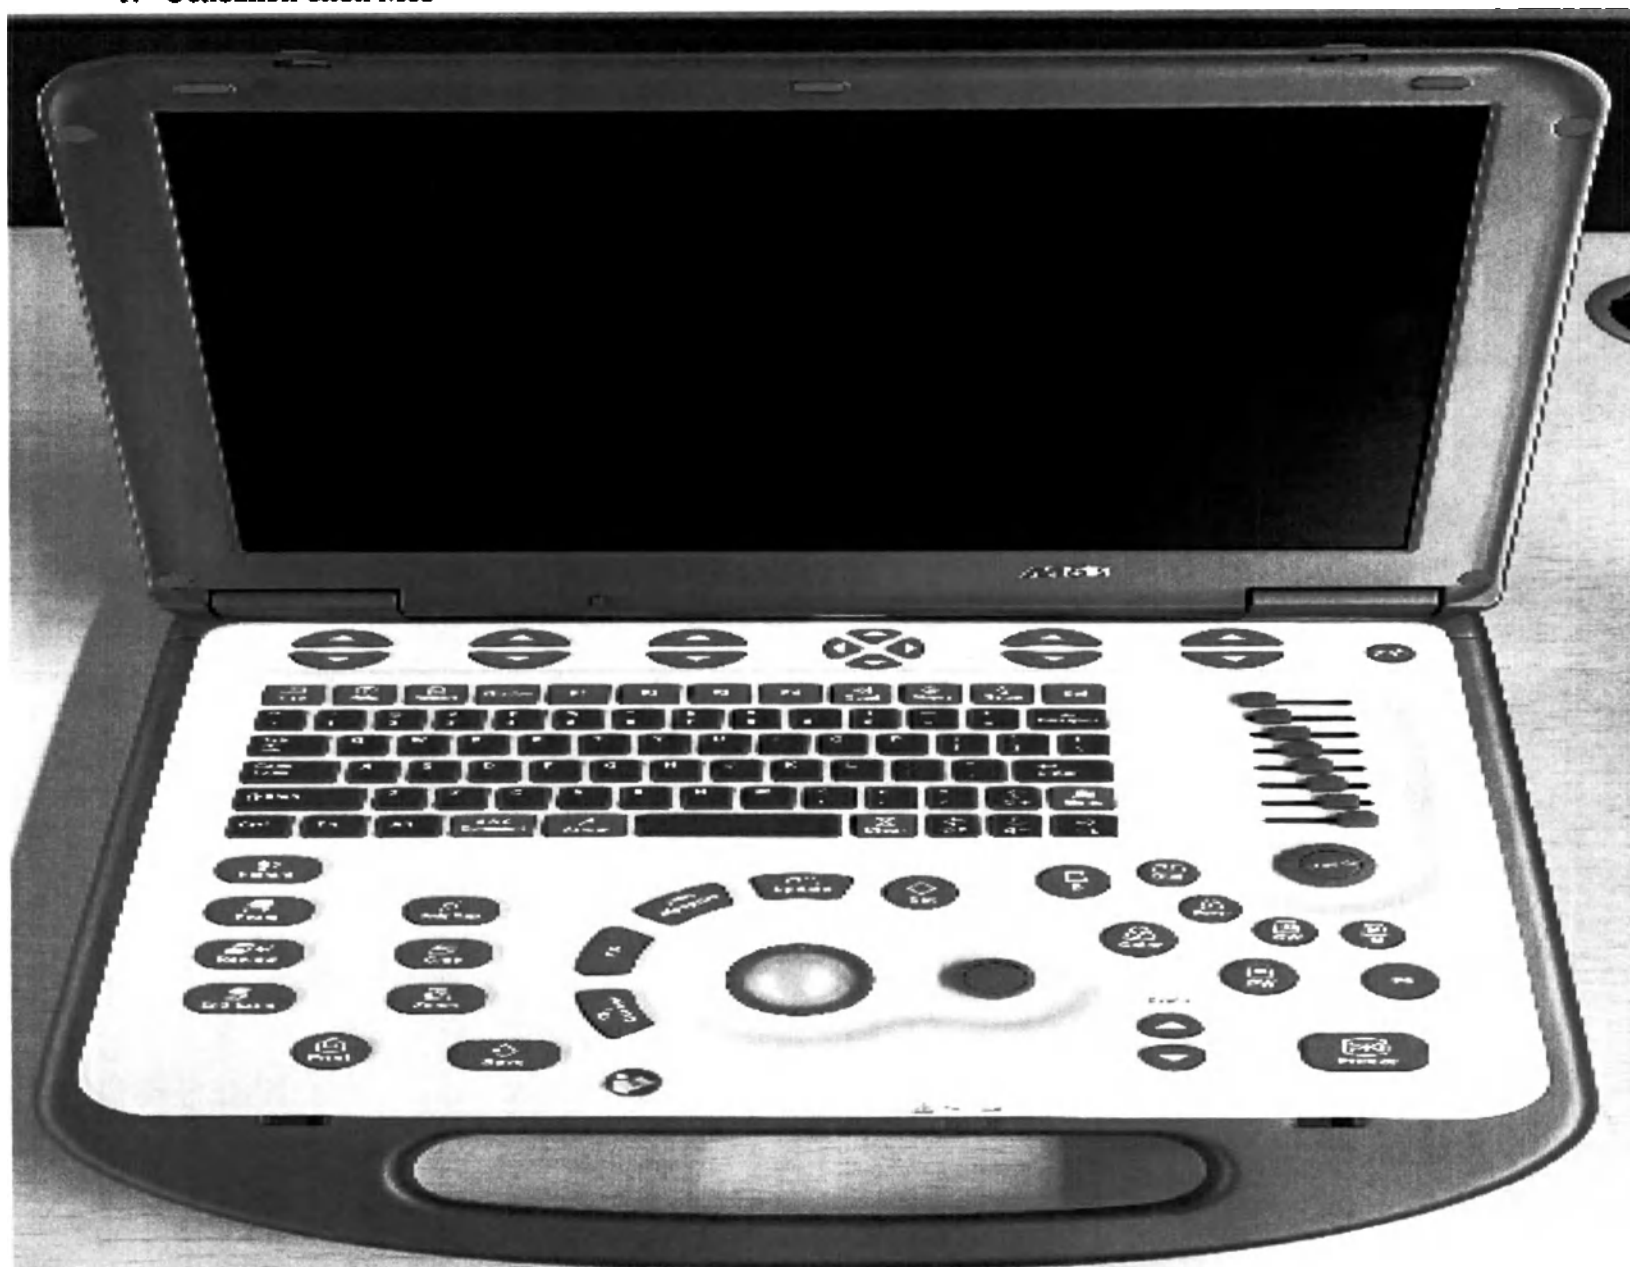


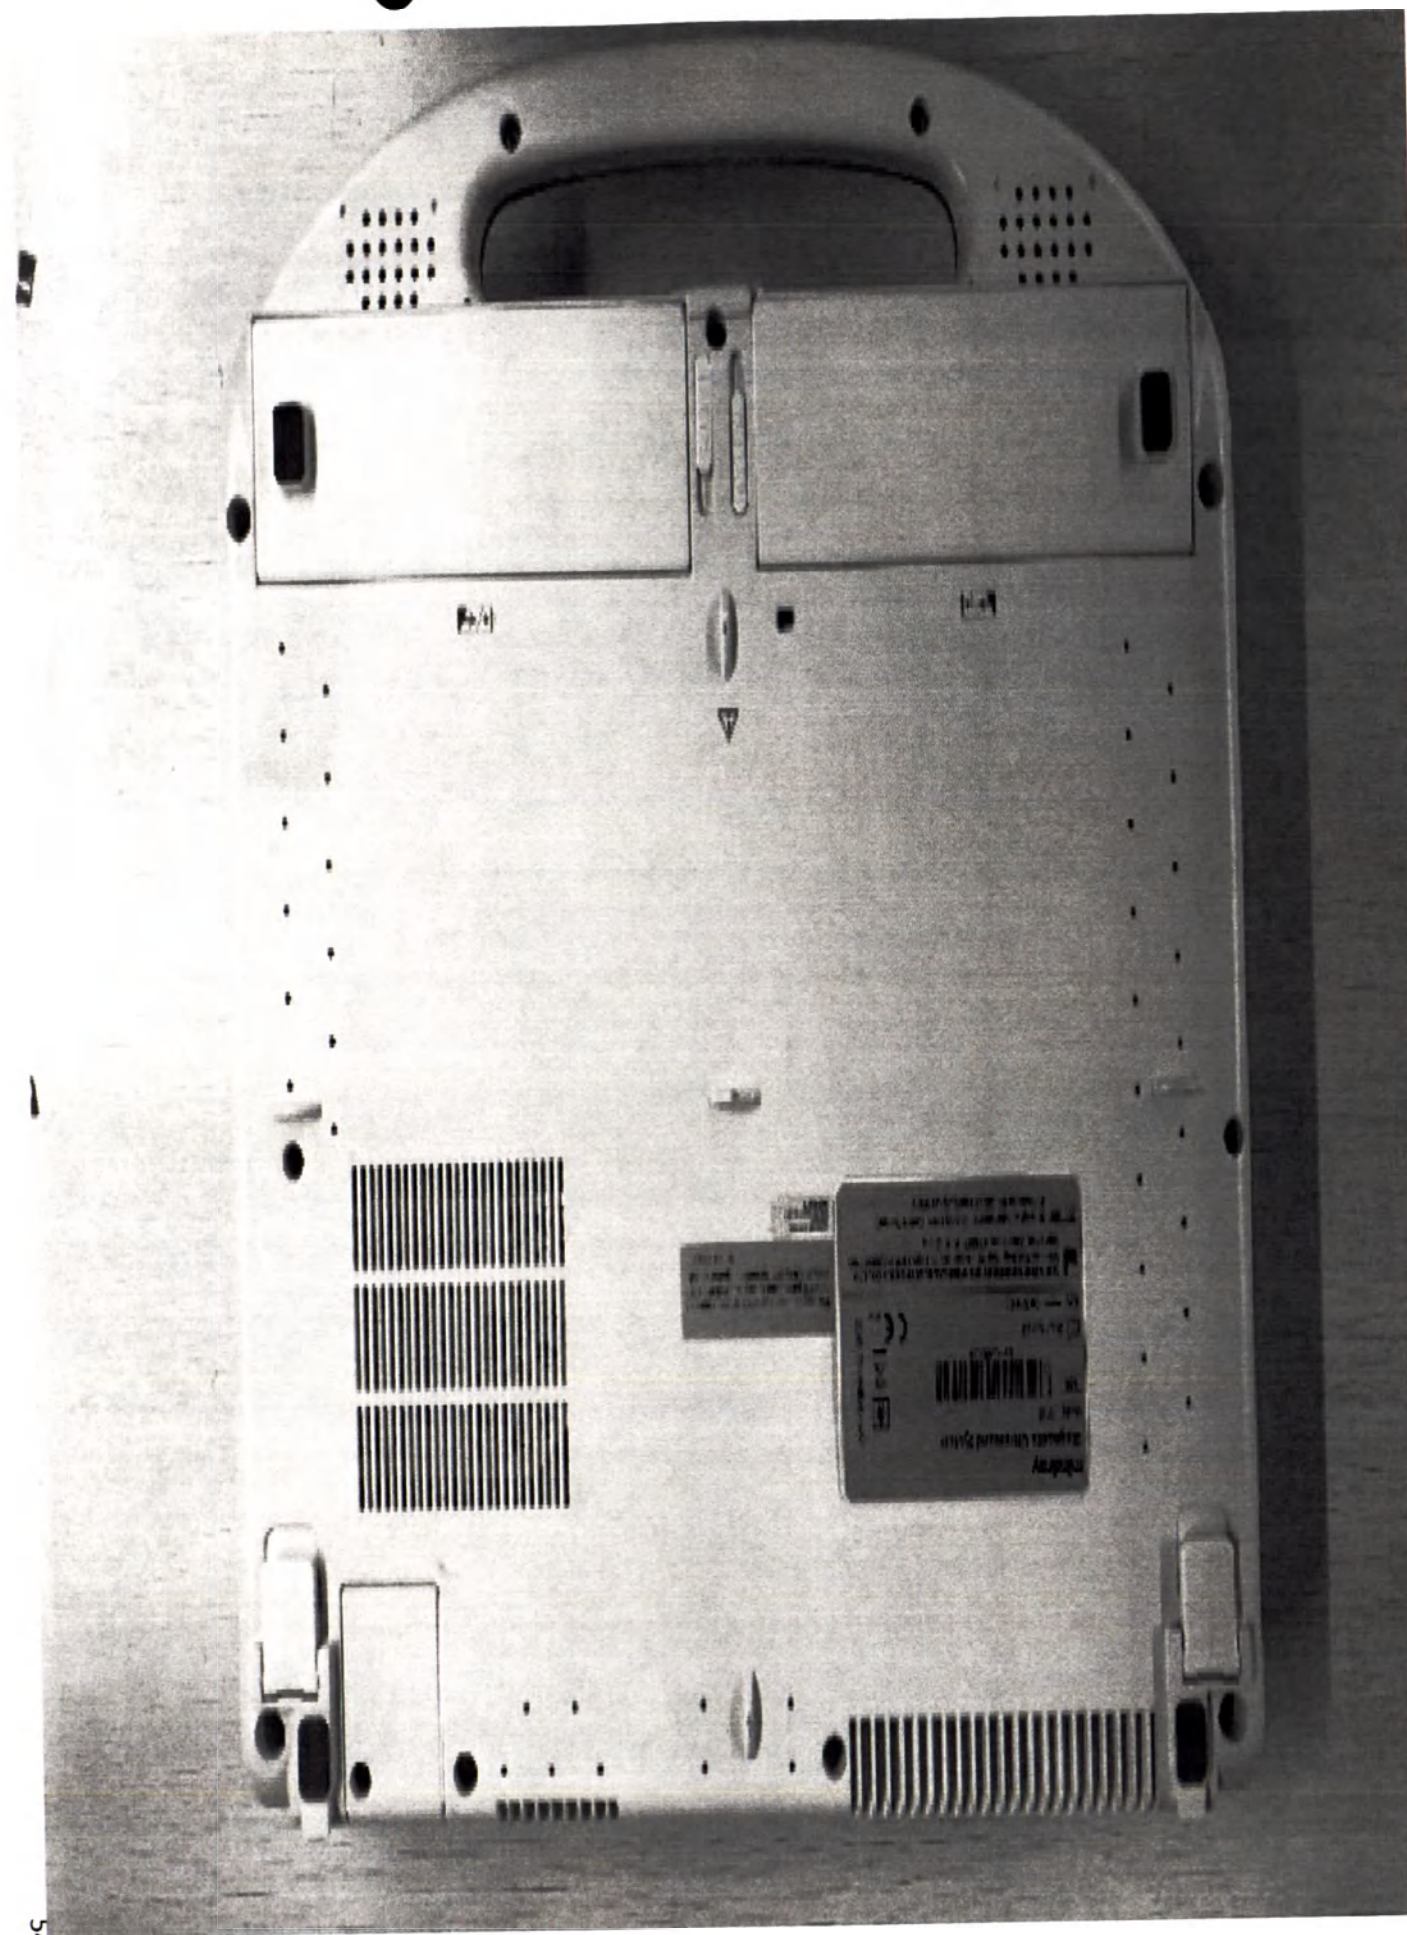


2. Руководство по эксплуатации




4. Кабель питания

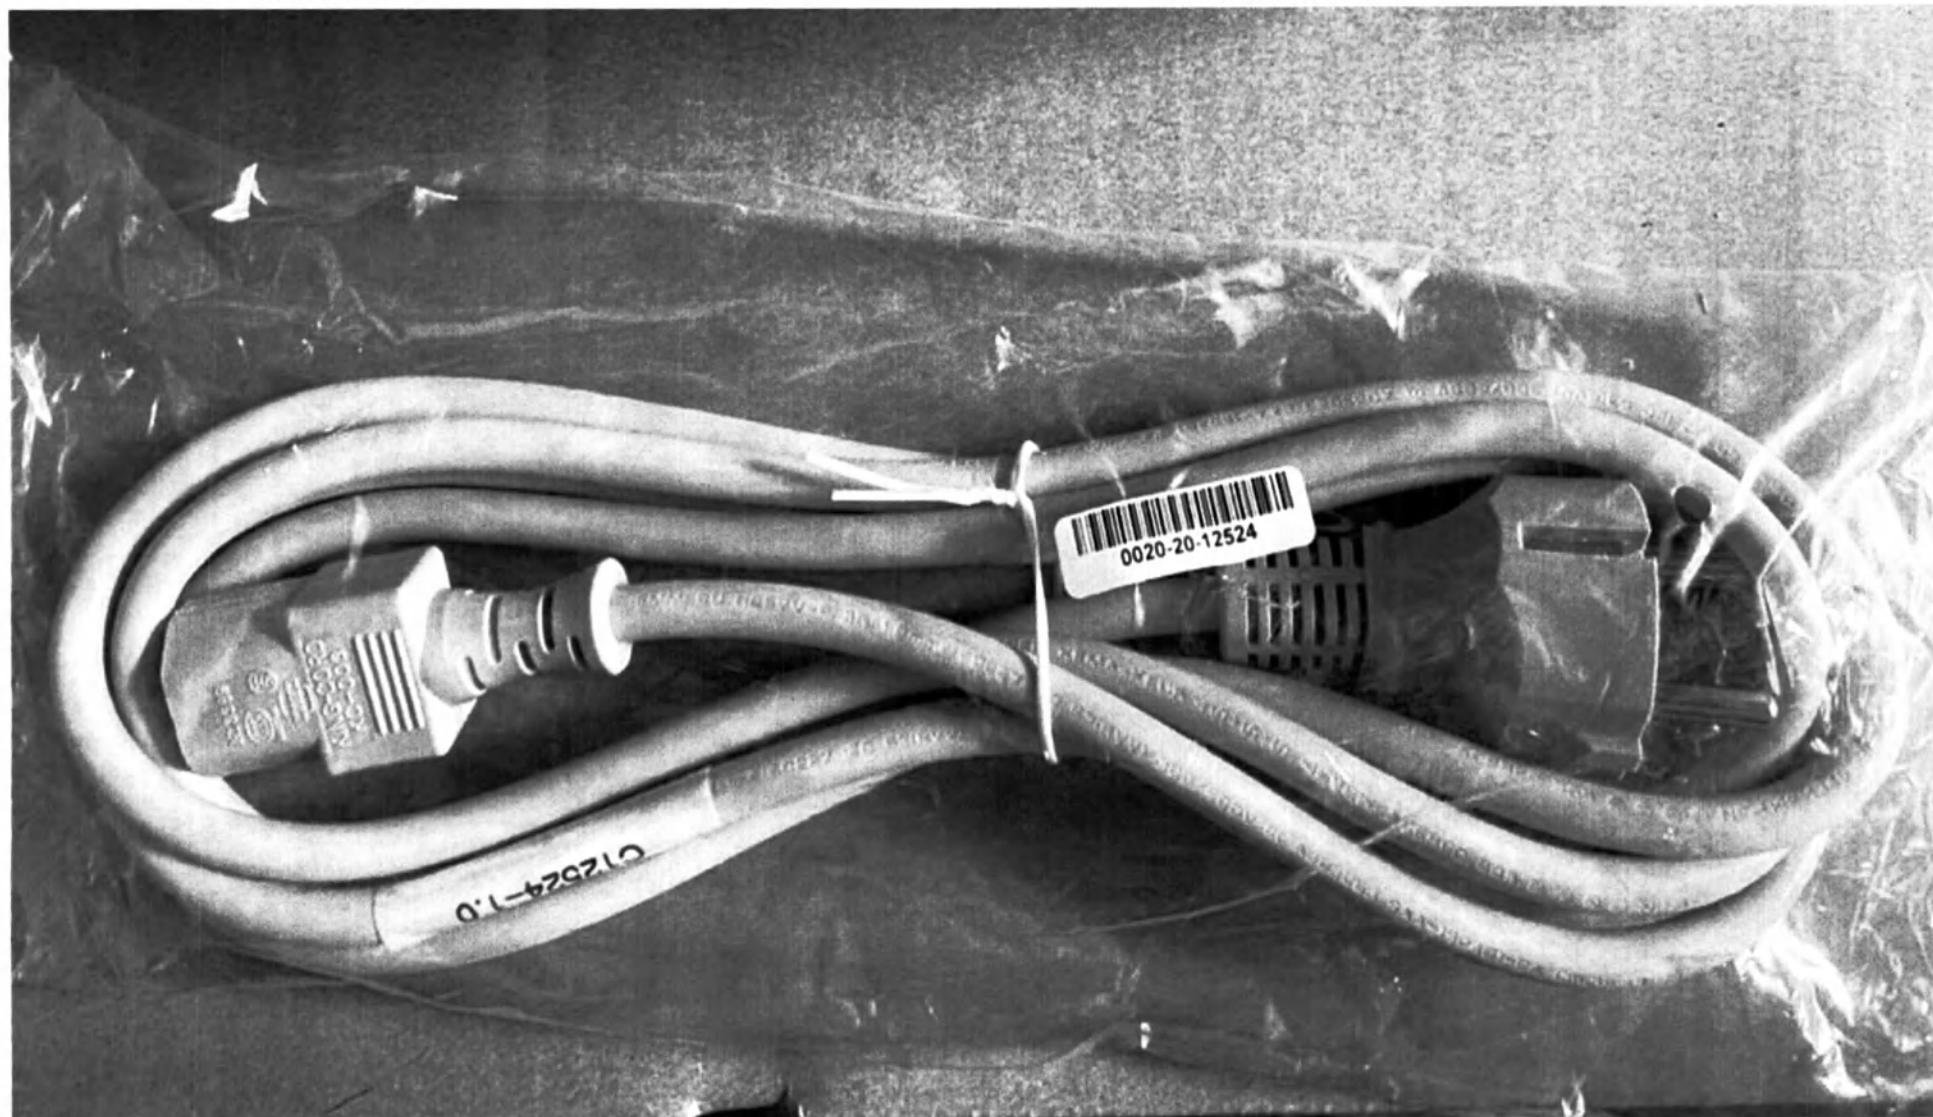

5. Накладка на панель управления(русифицированная)

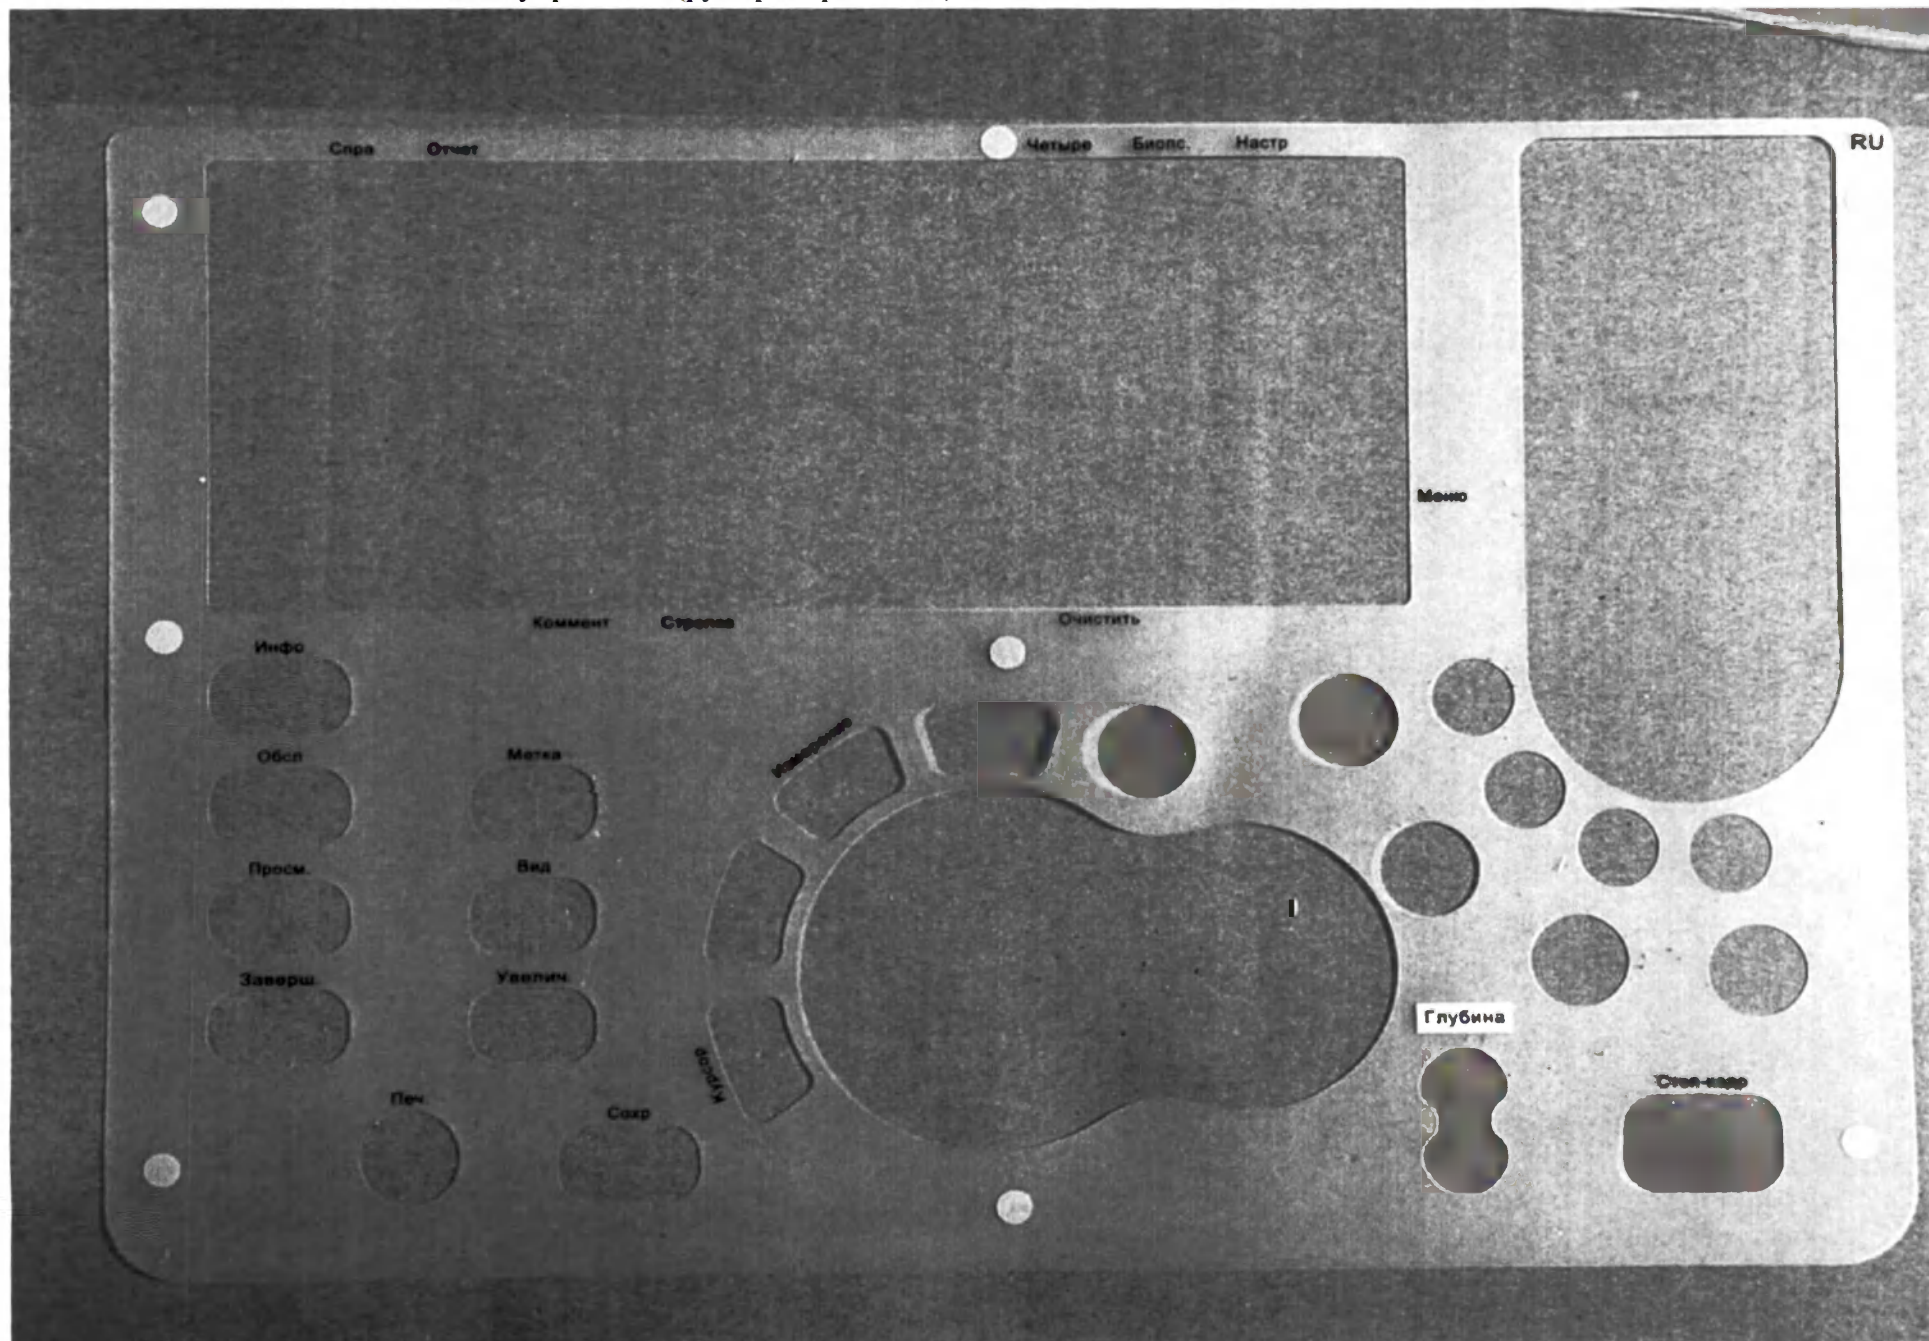


6. Адаптер питания

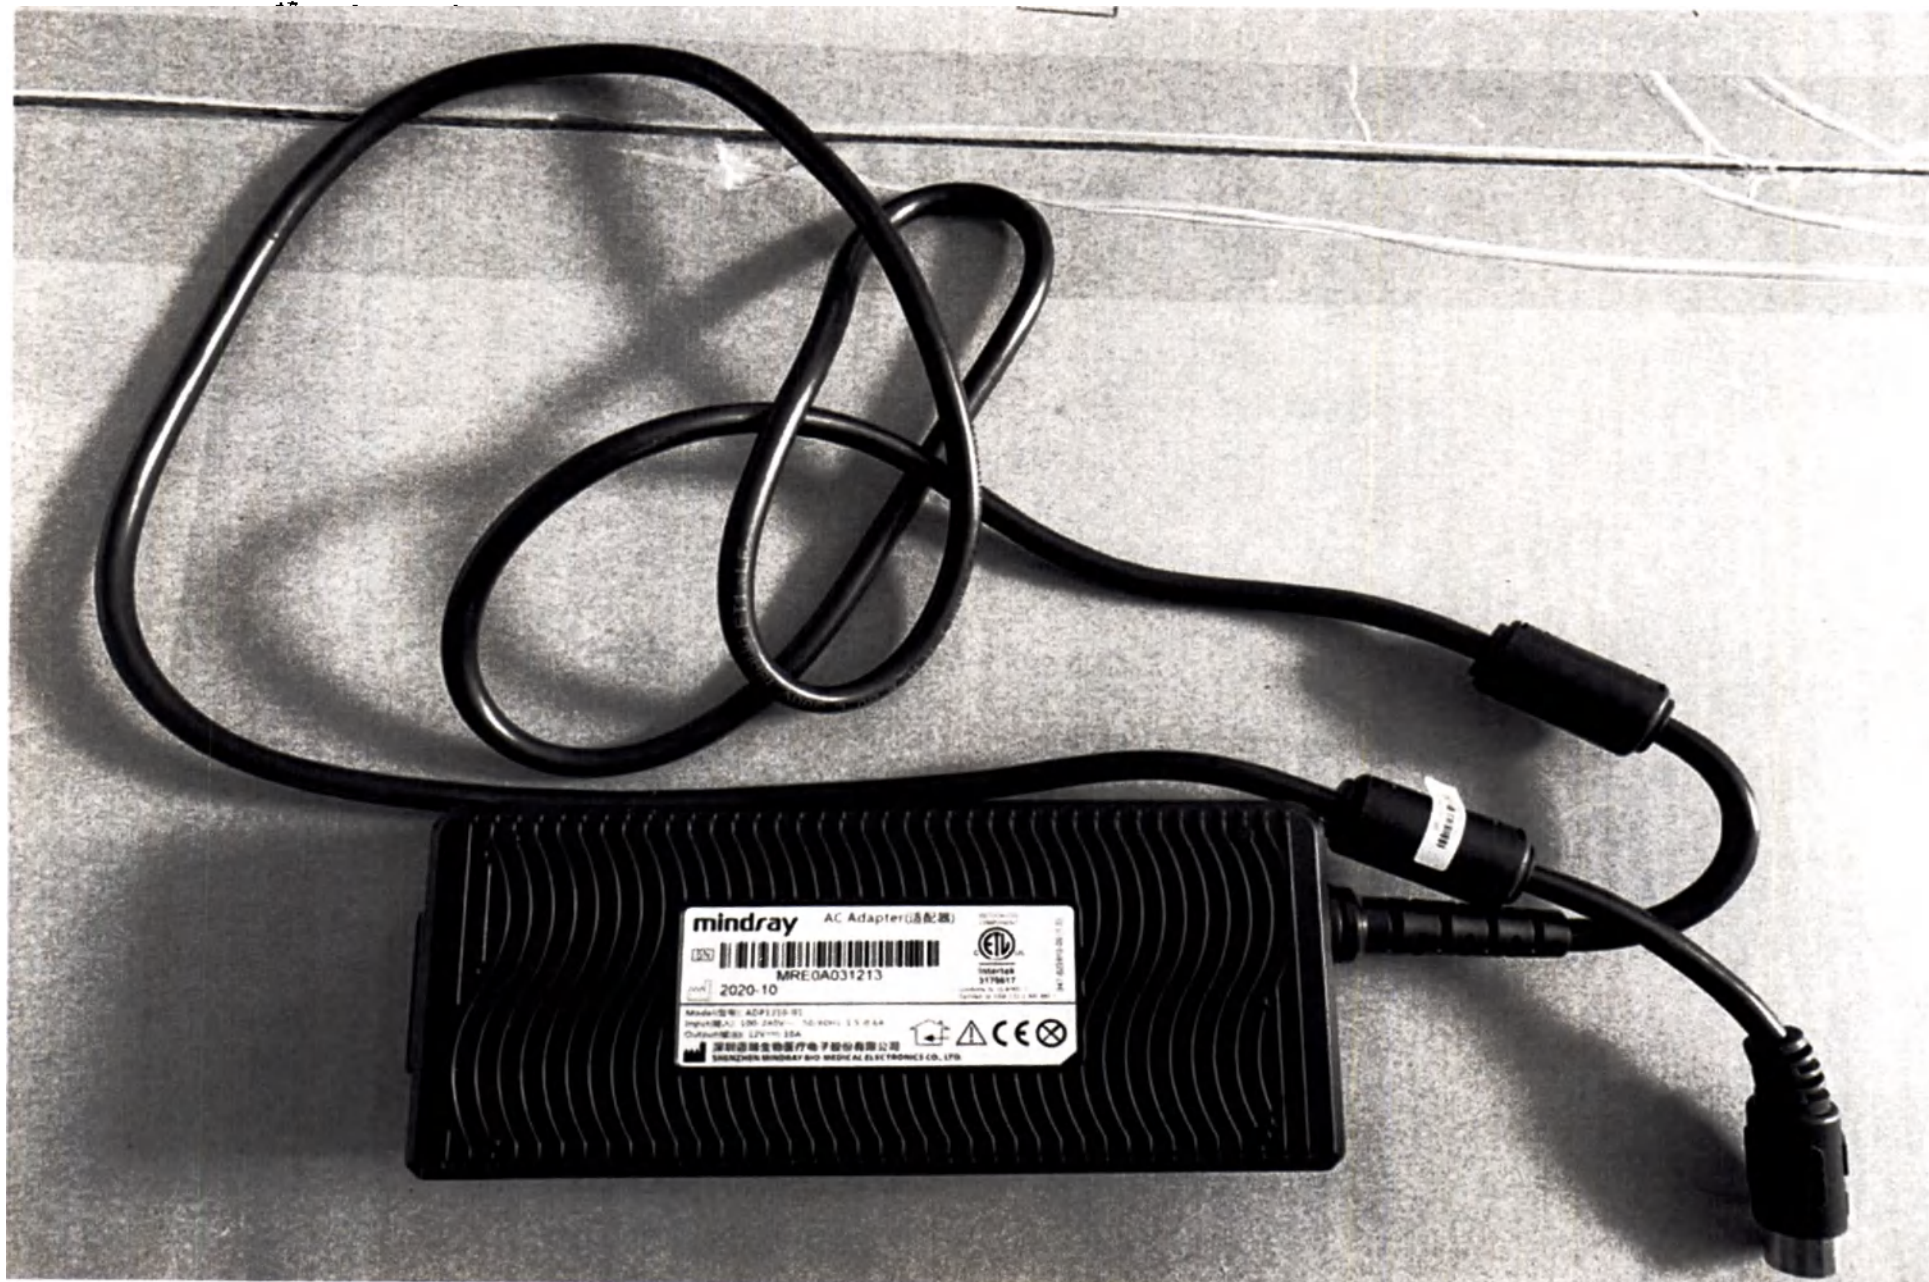


7. Аккумуляторная батарея




8. Разветвитель для датчиков

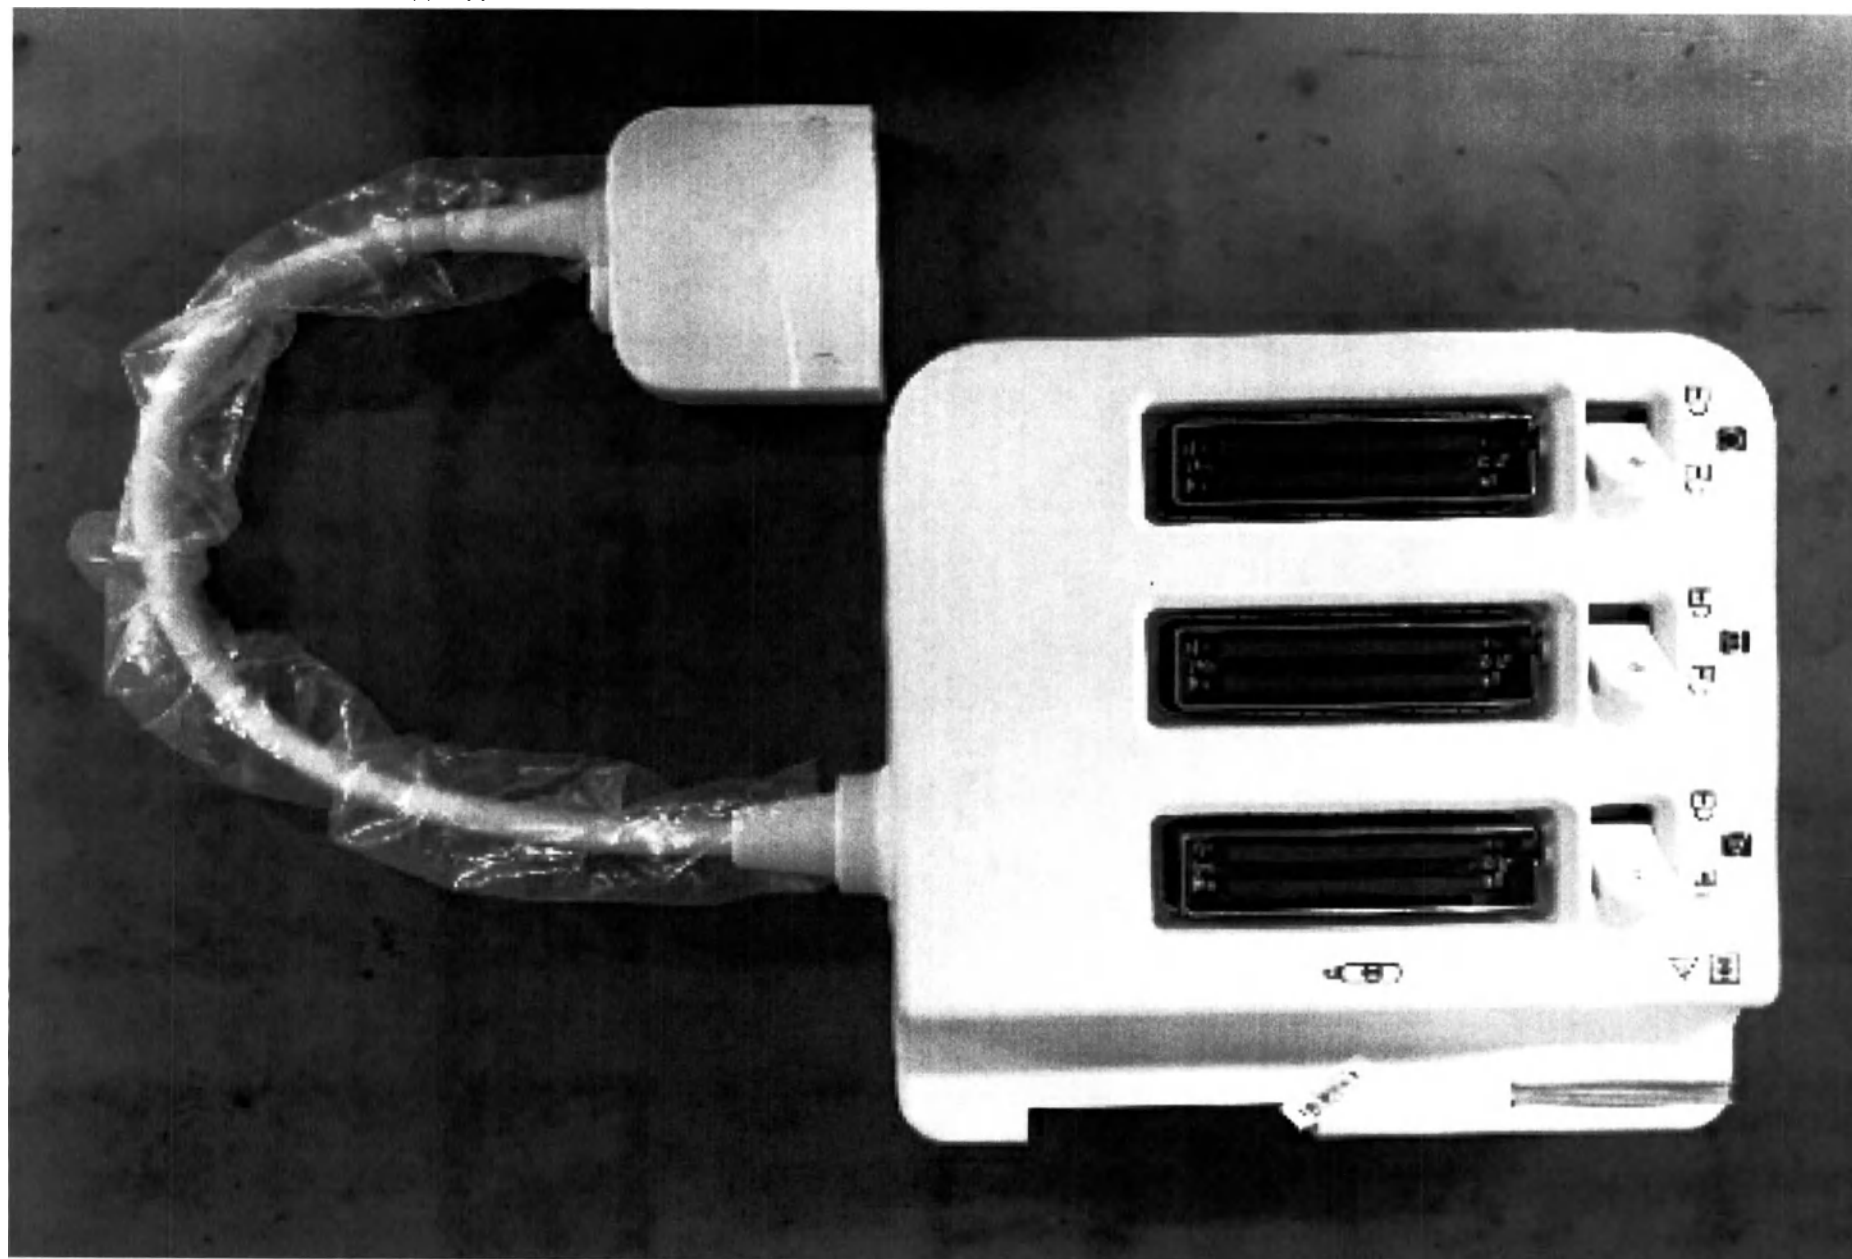


9. Уголок для крепления разветвителя для датчиков

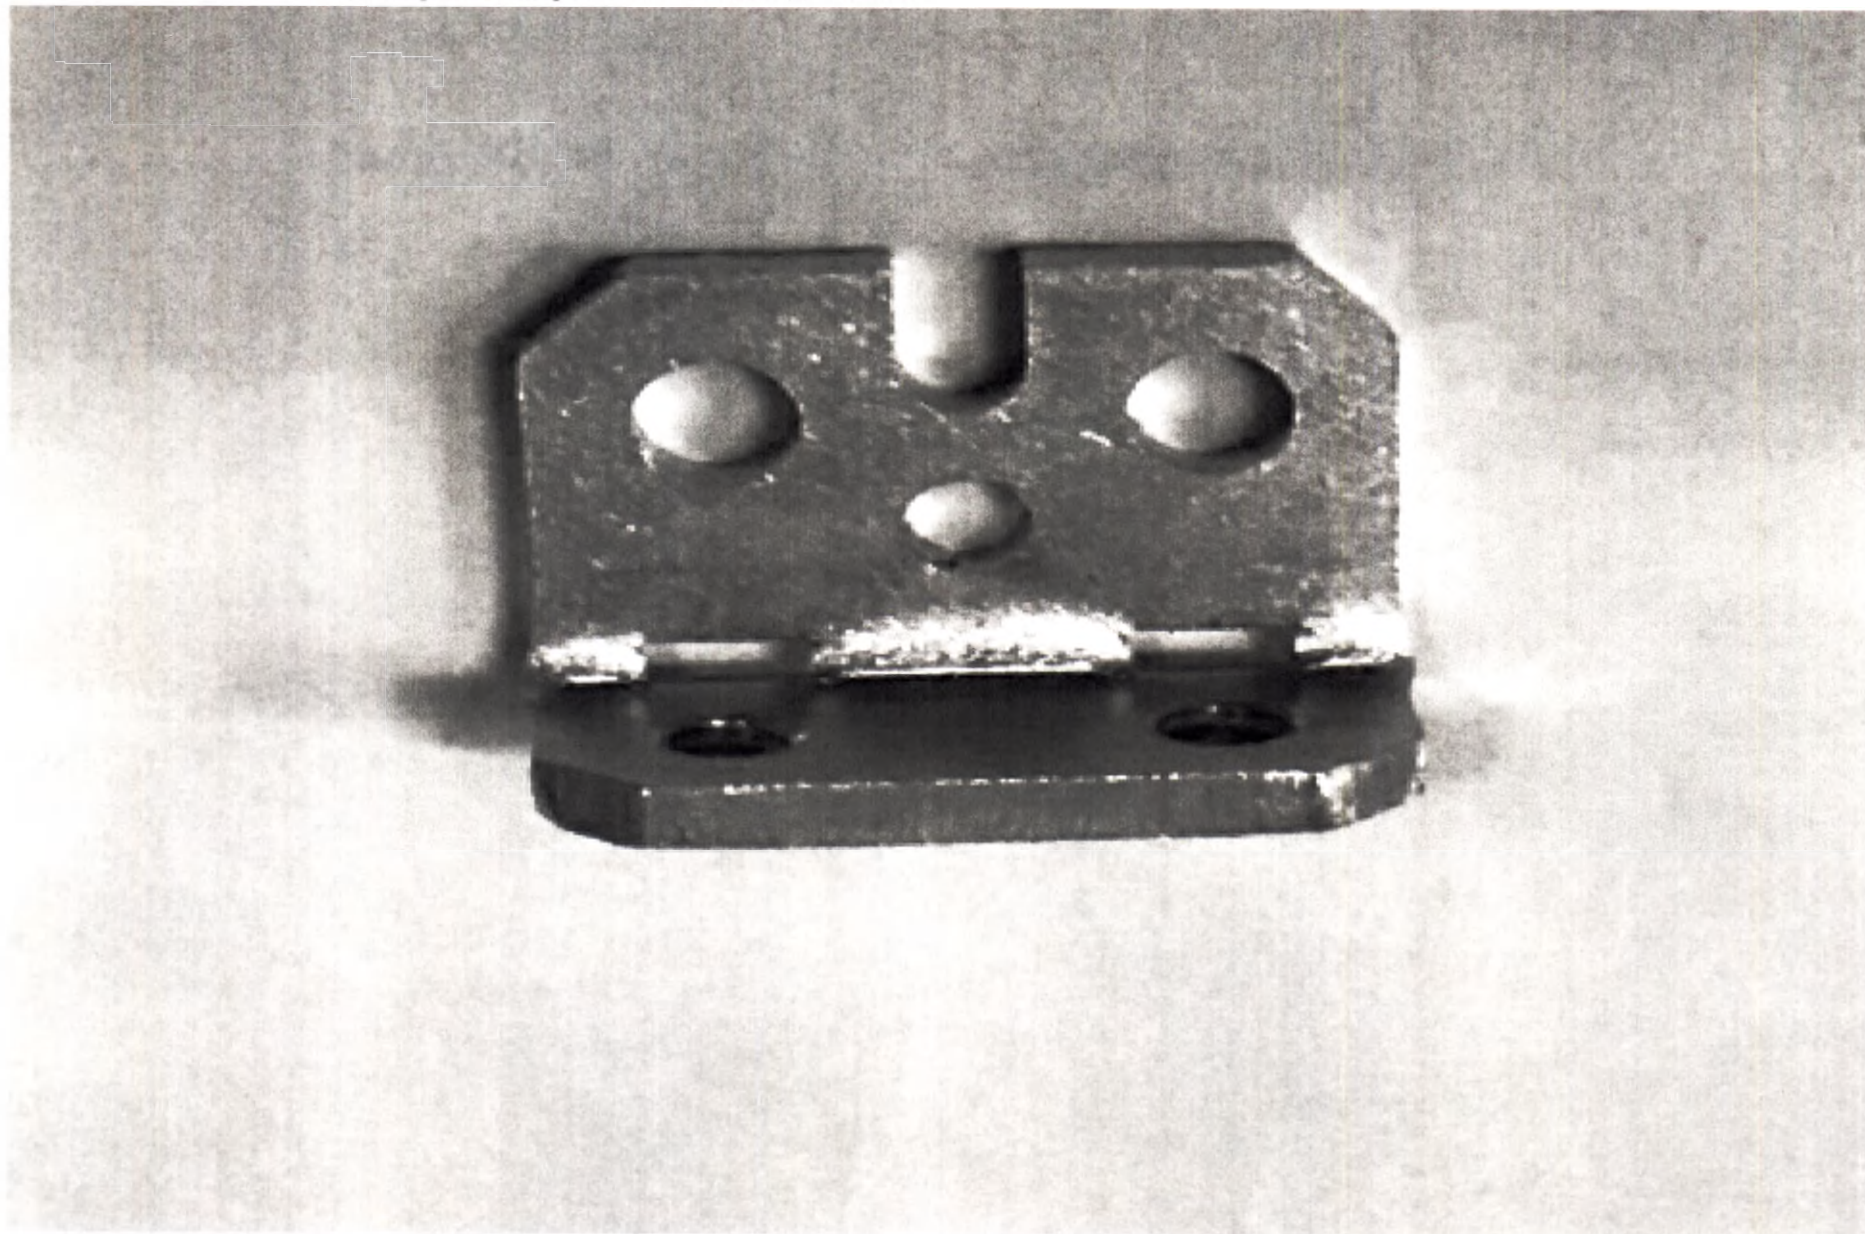


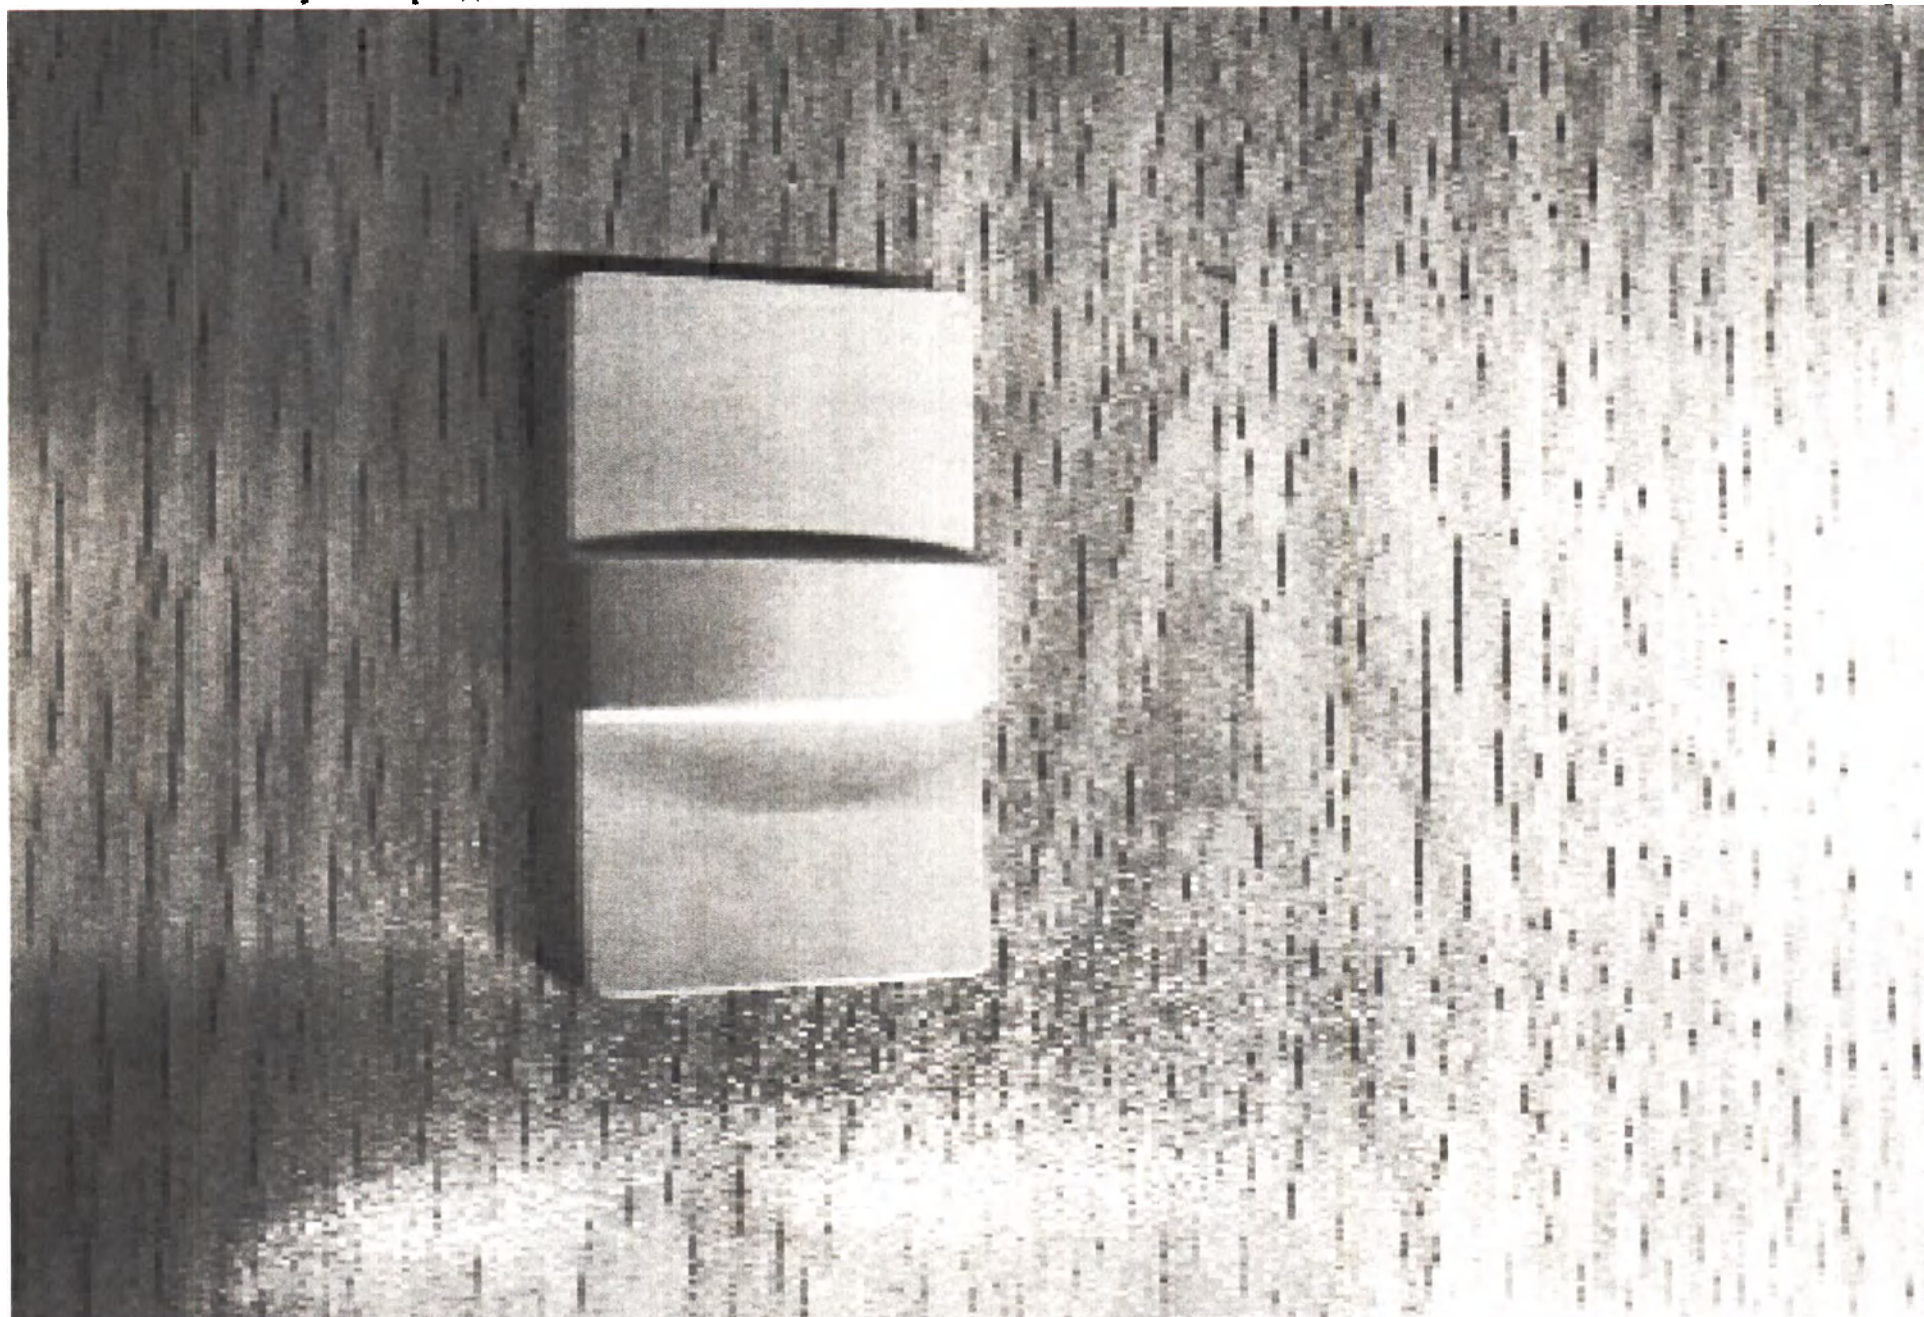



11. Шайба плоская

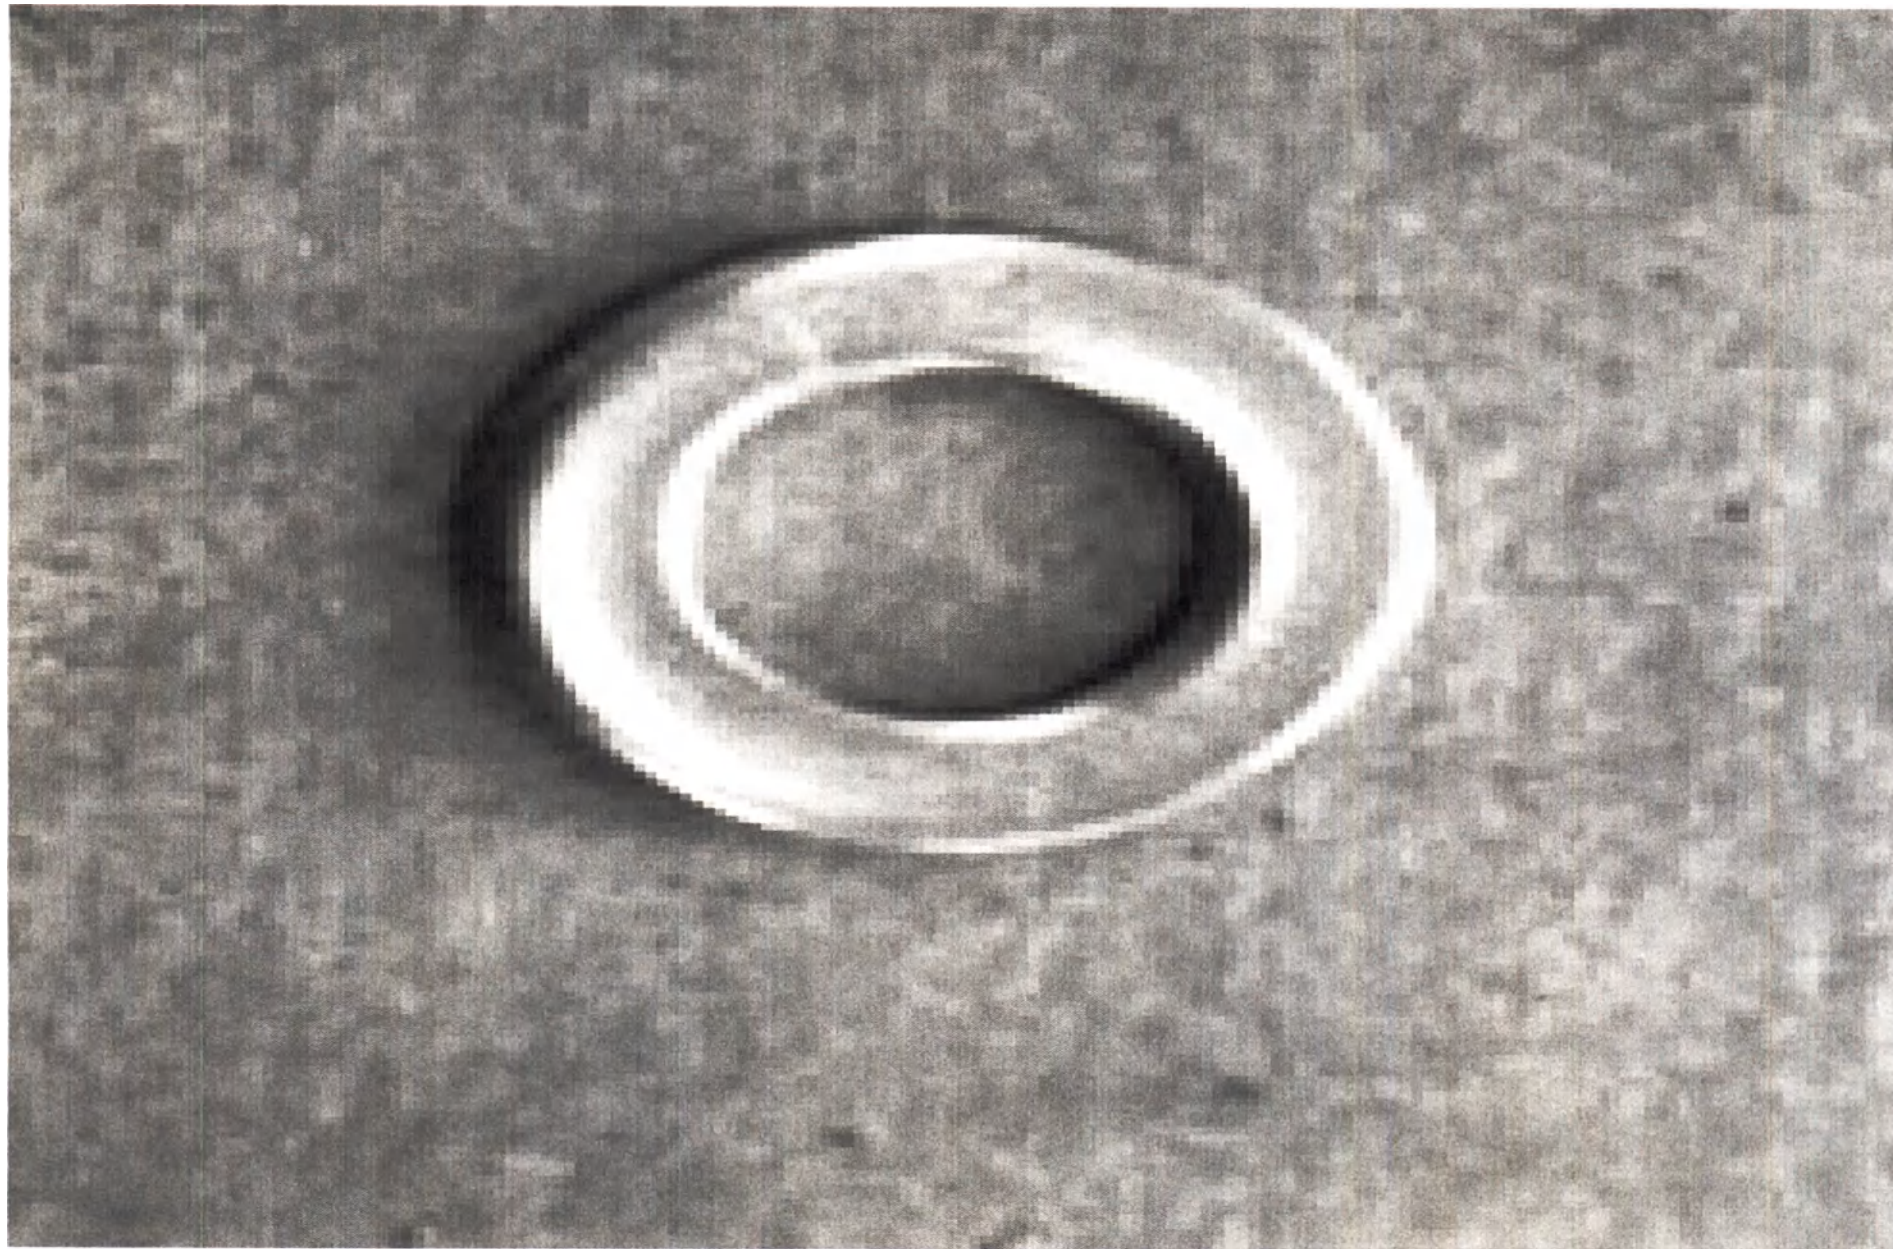

12. Шайба гроверная (пружинная)

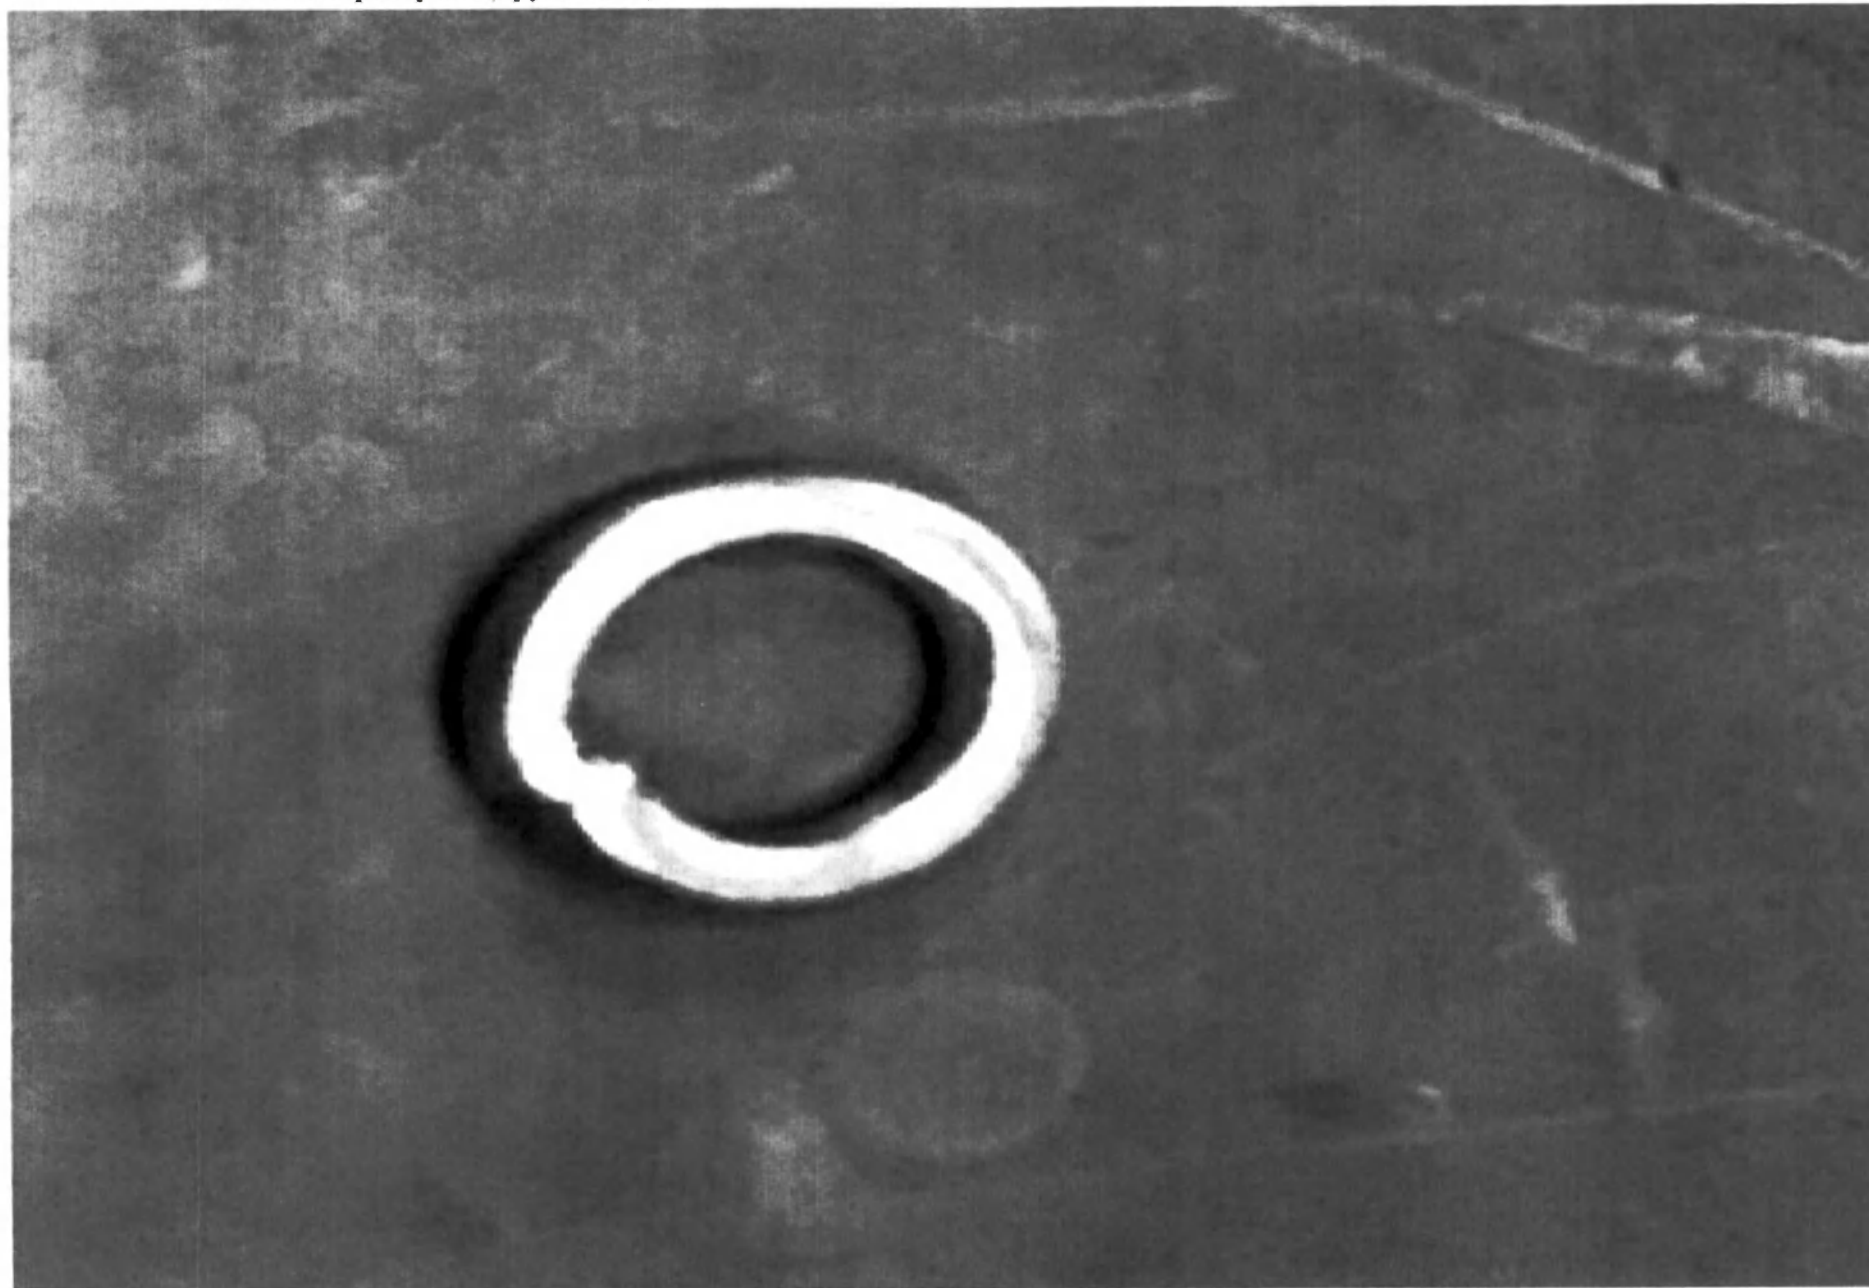

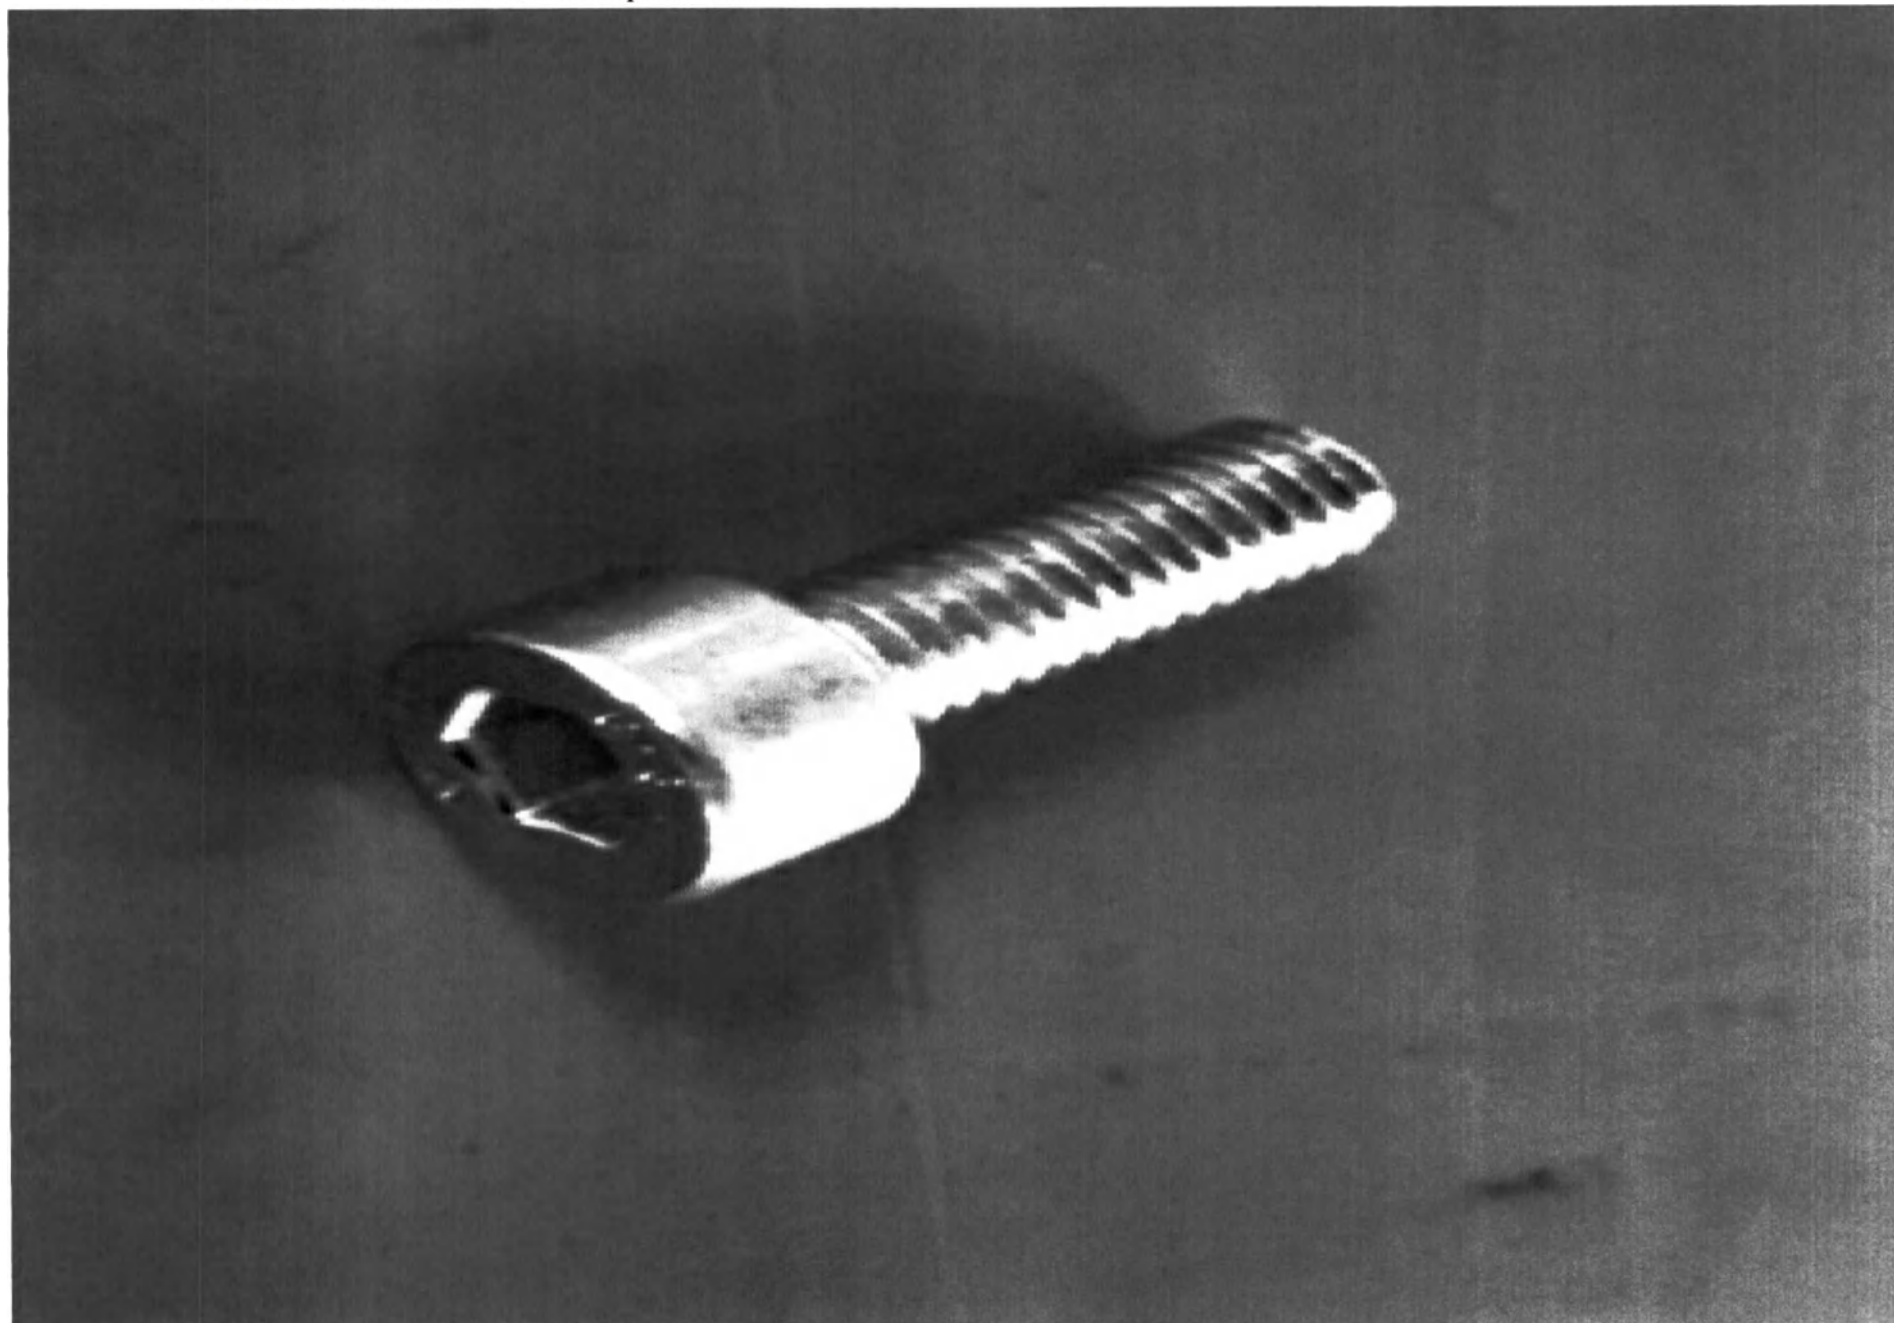

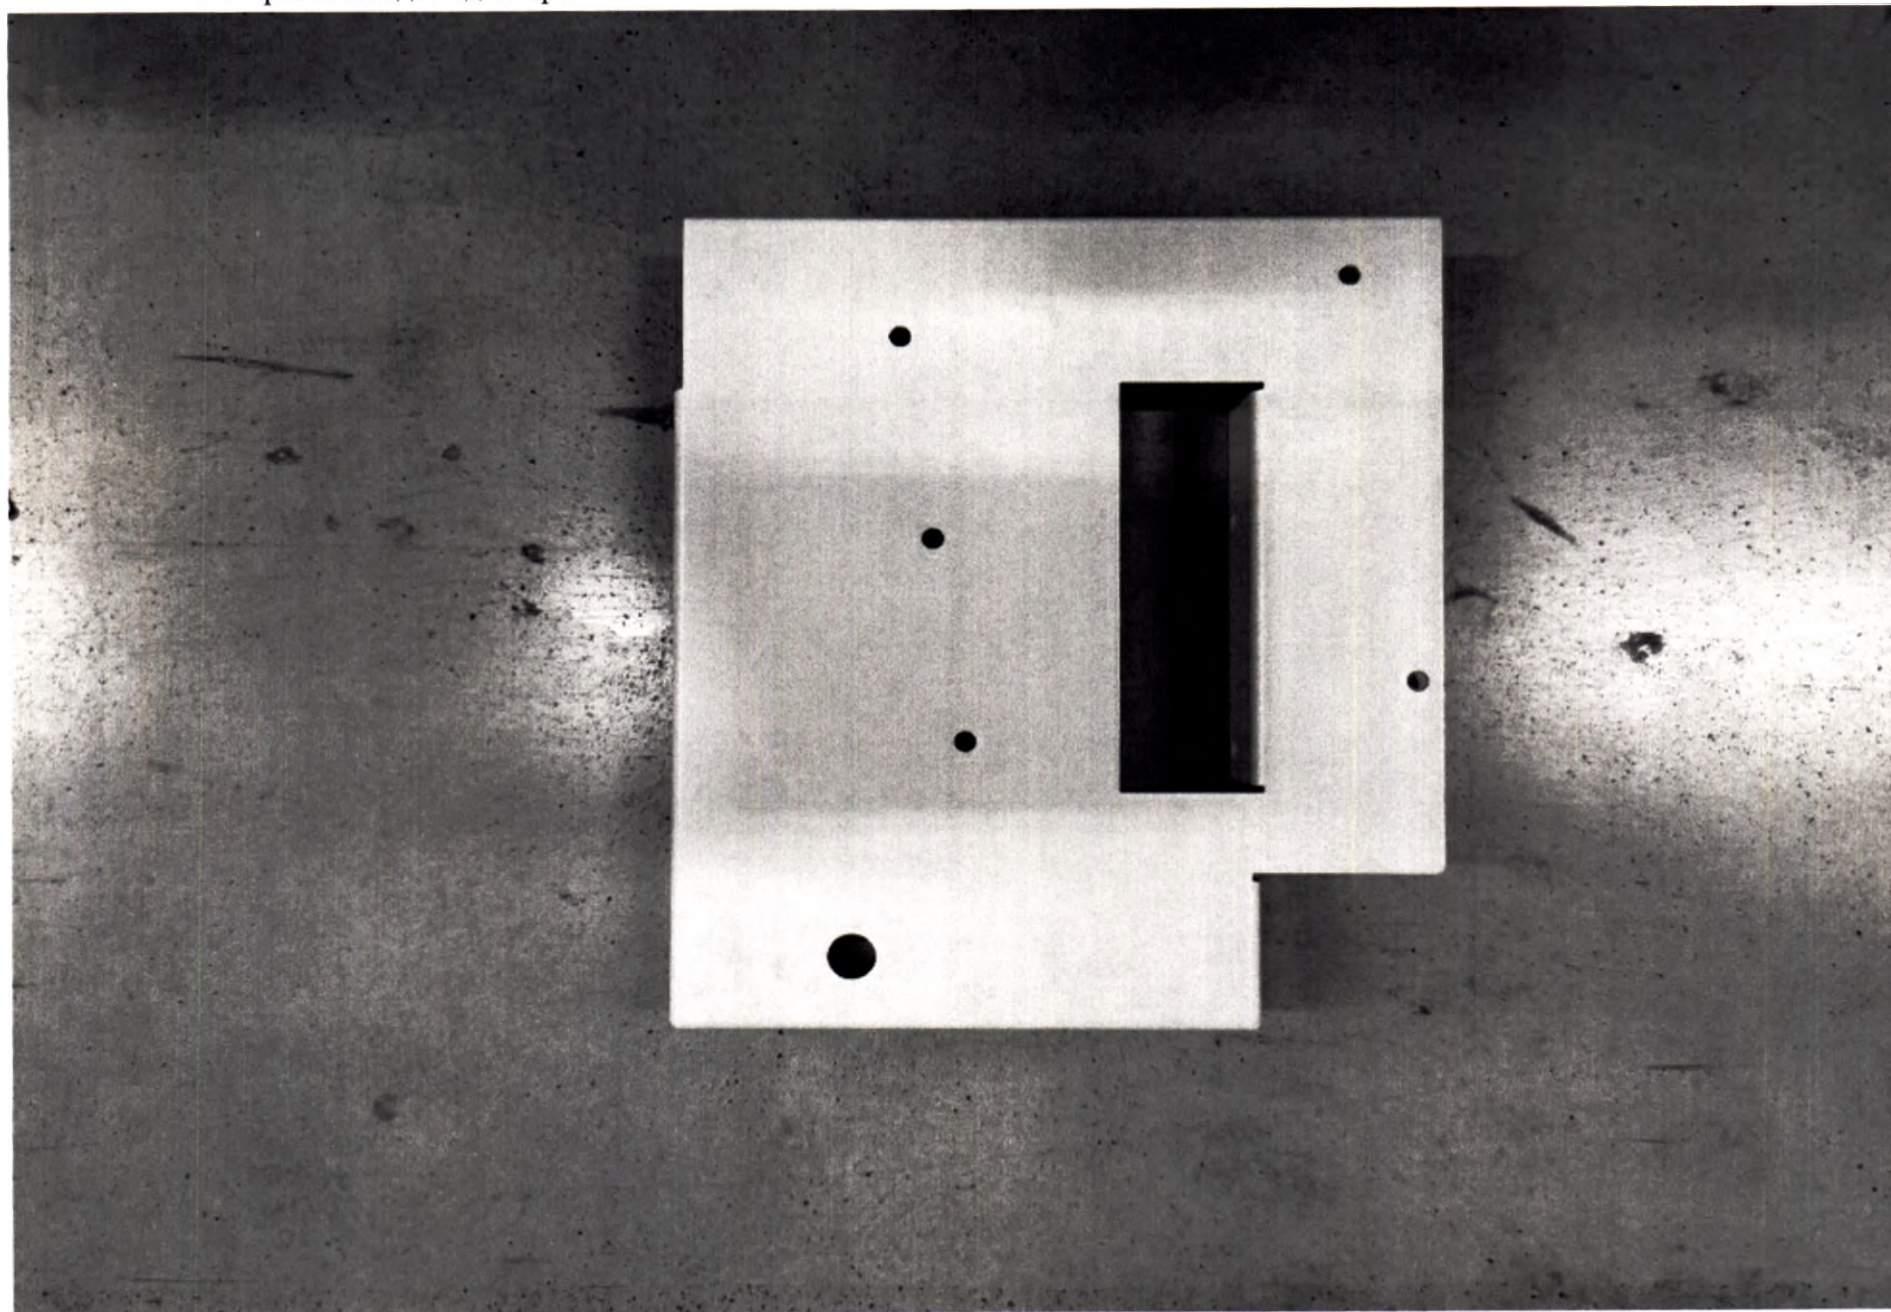


15. Винт с сборе с плоской и гроверной шайбами и головкой под крестовую отвертку




16. Беспроводной USB-адаптер



17. Модуль расширения портов (док-станция) для ввода/вывода сигналов

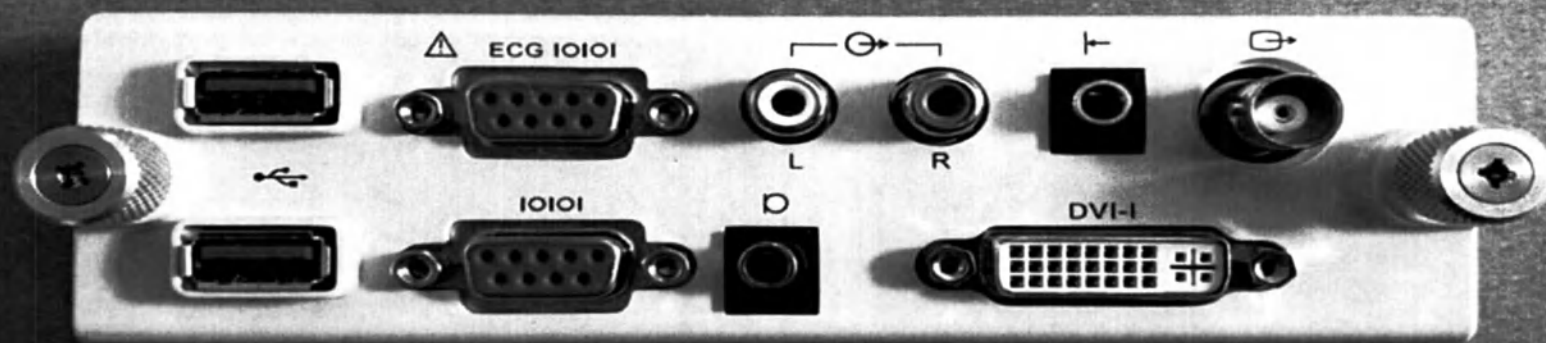




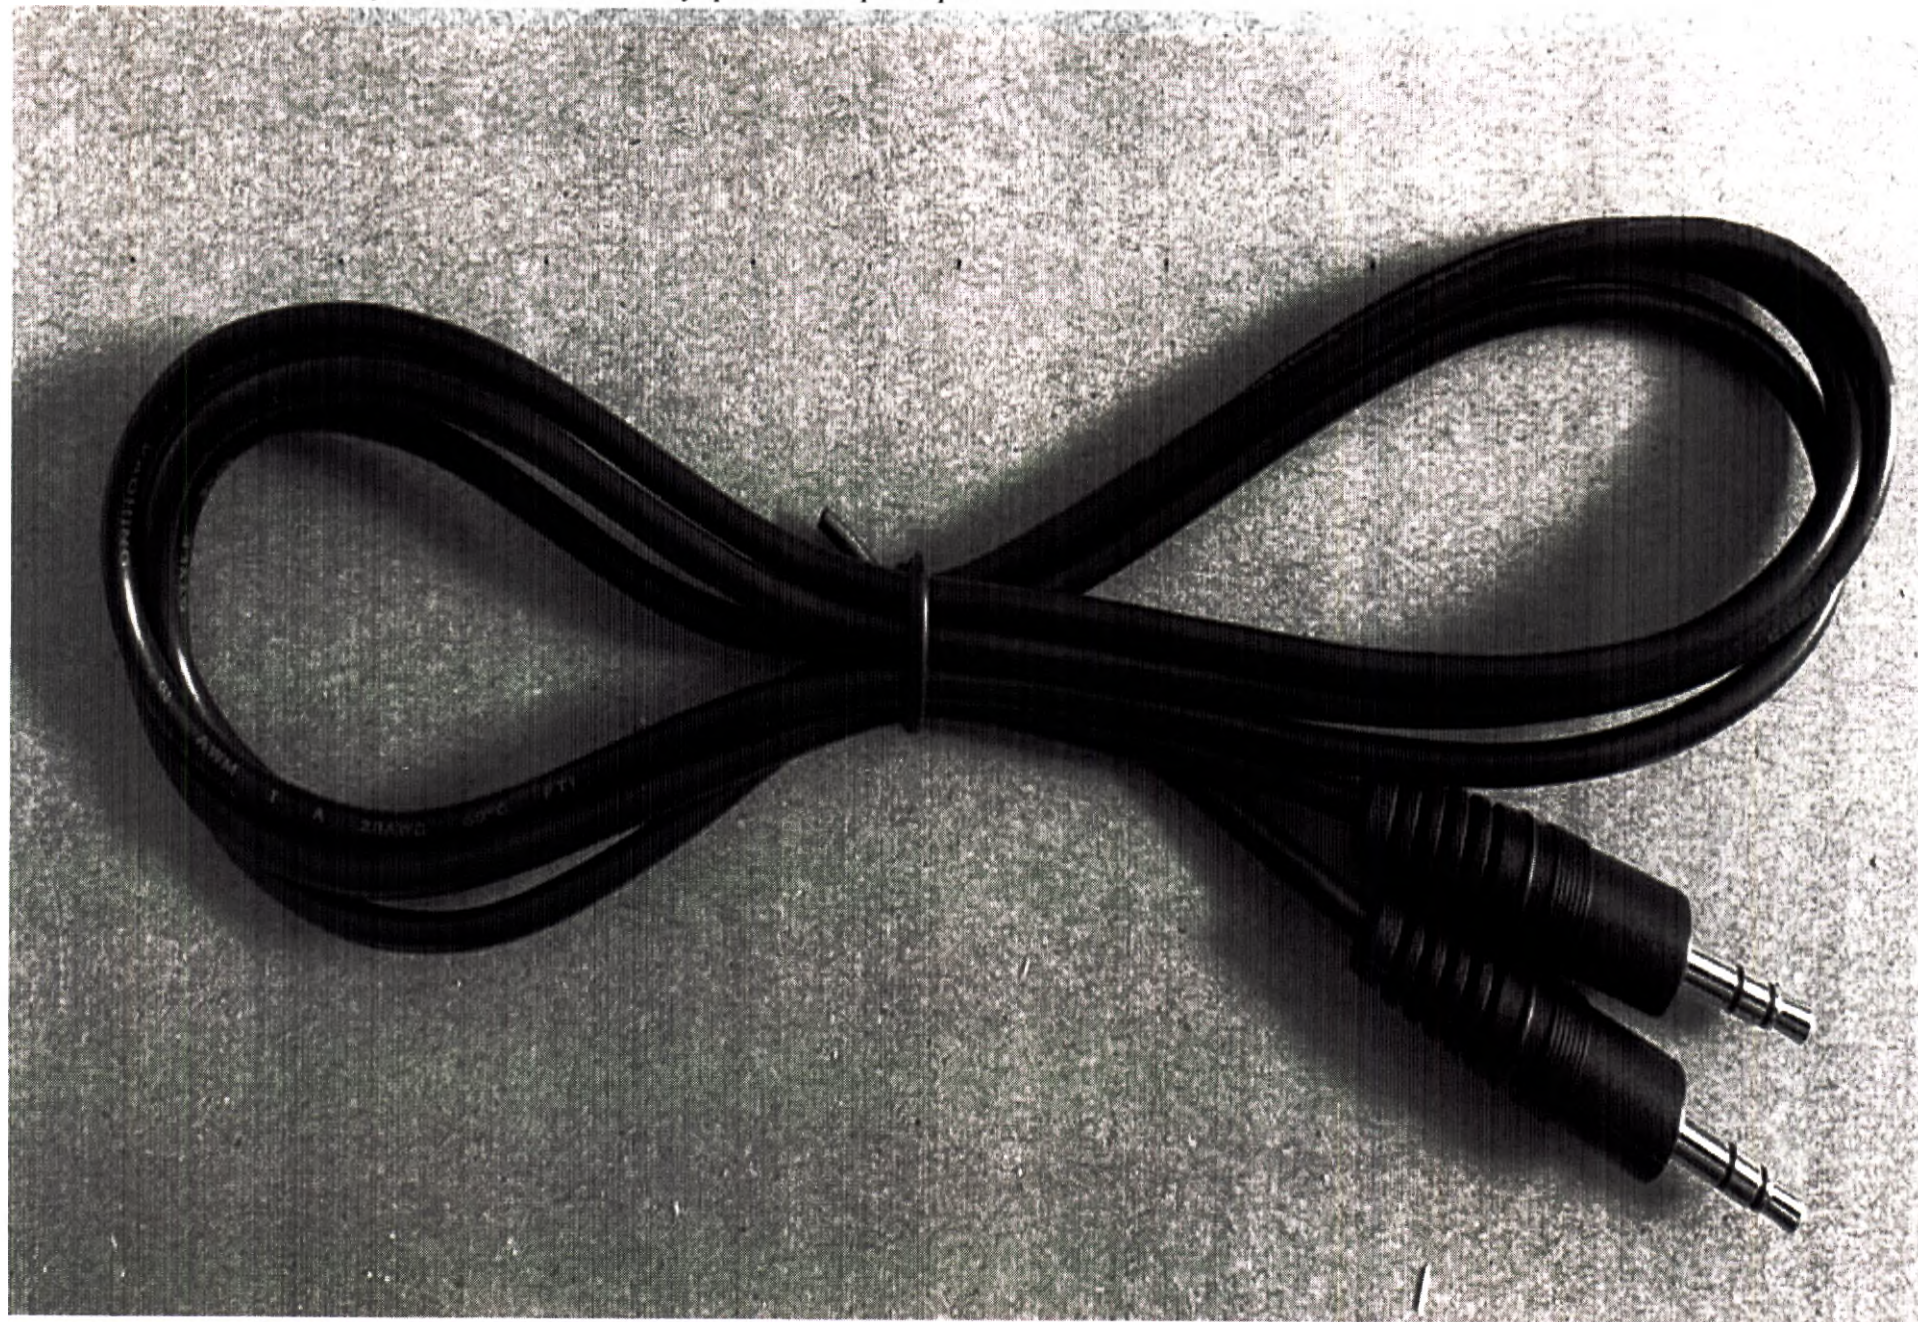






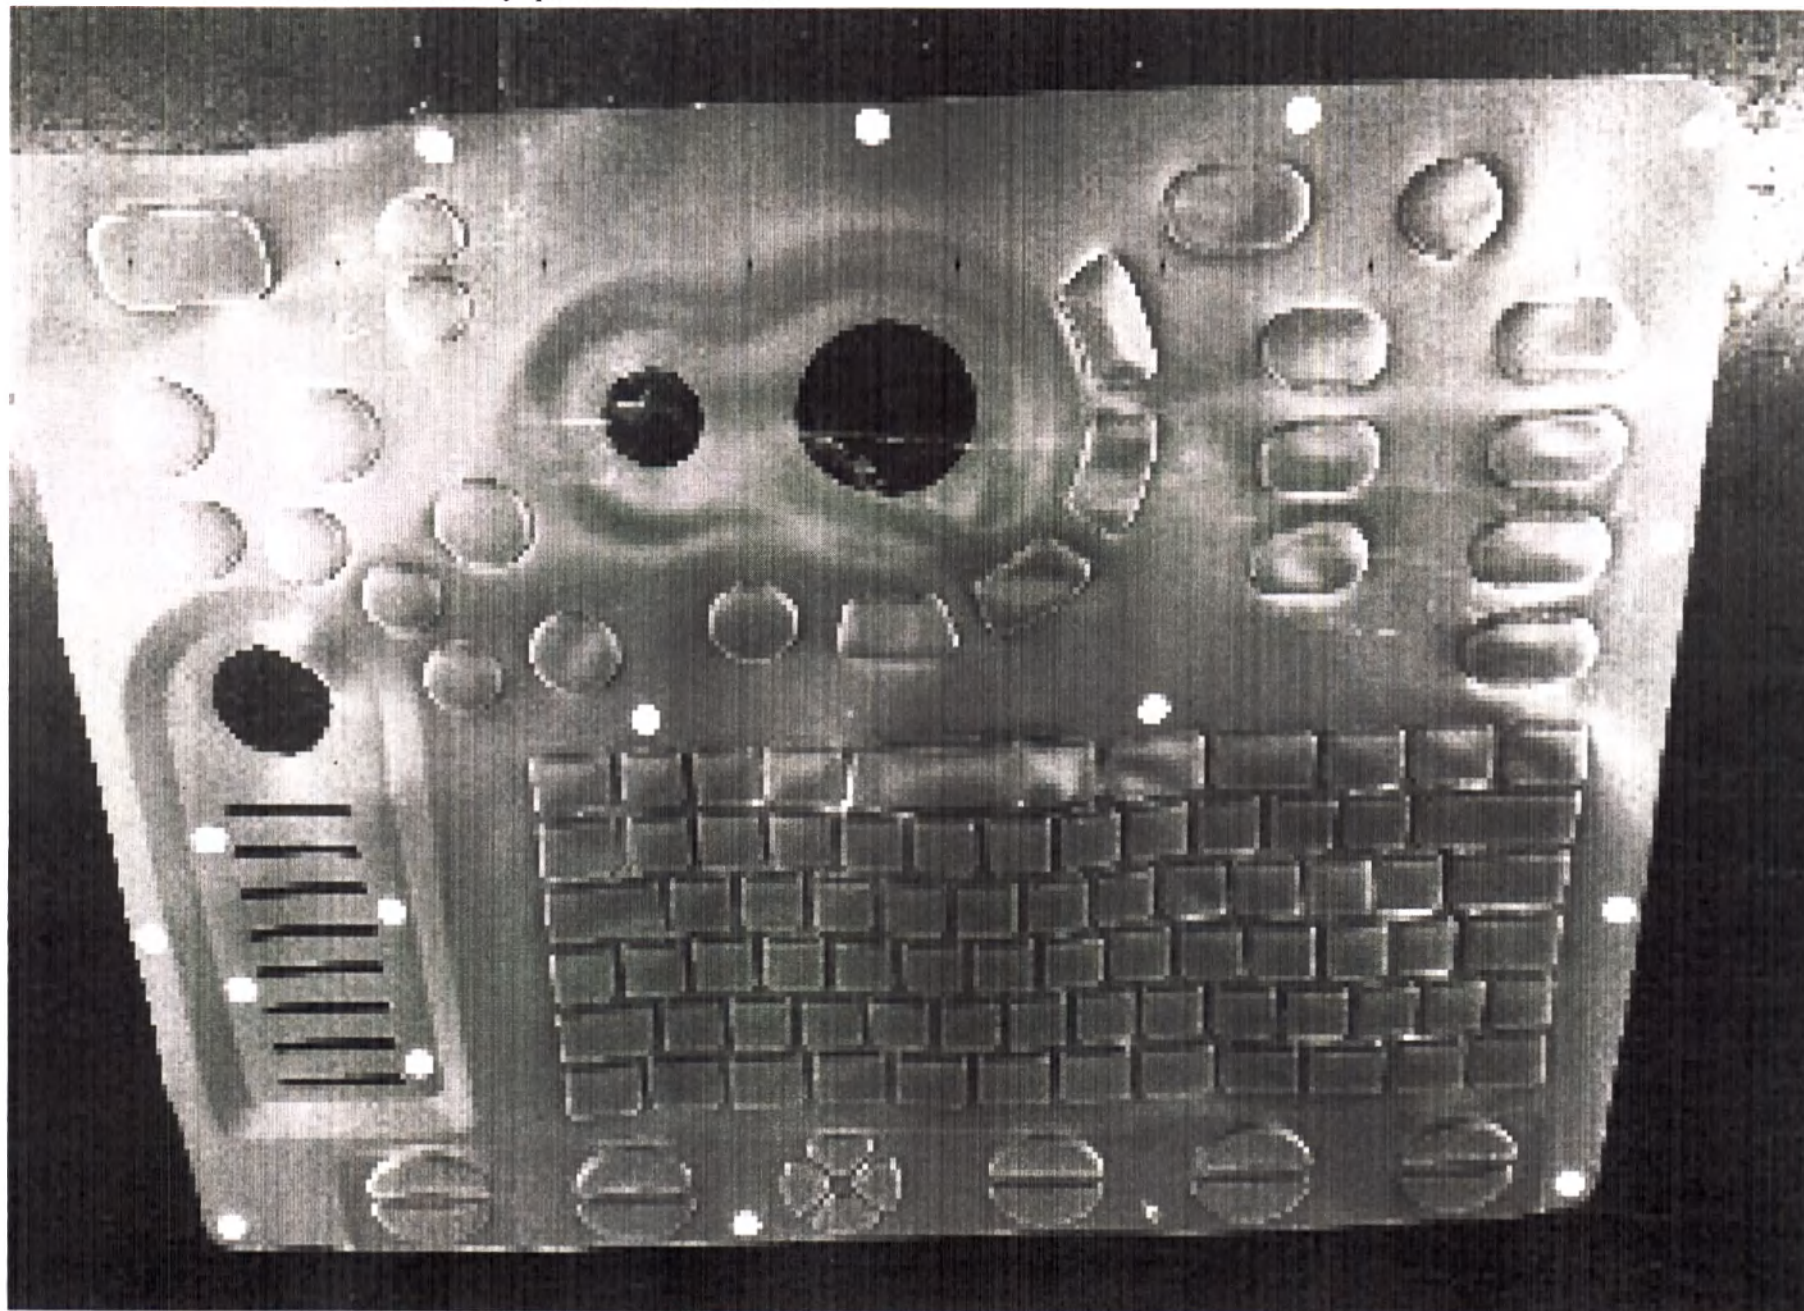





24. Датчики ультразвуковые


25. 1. Датчик ультразвуковой фазированный 2P2s

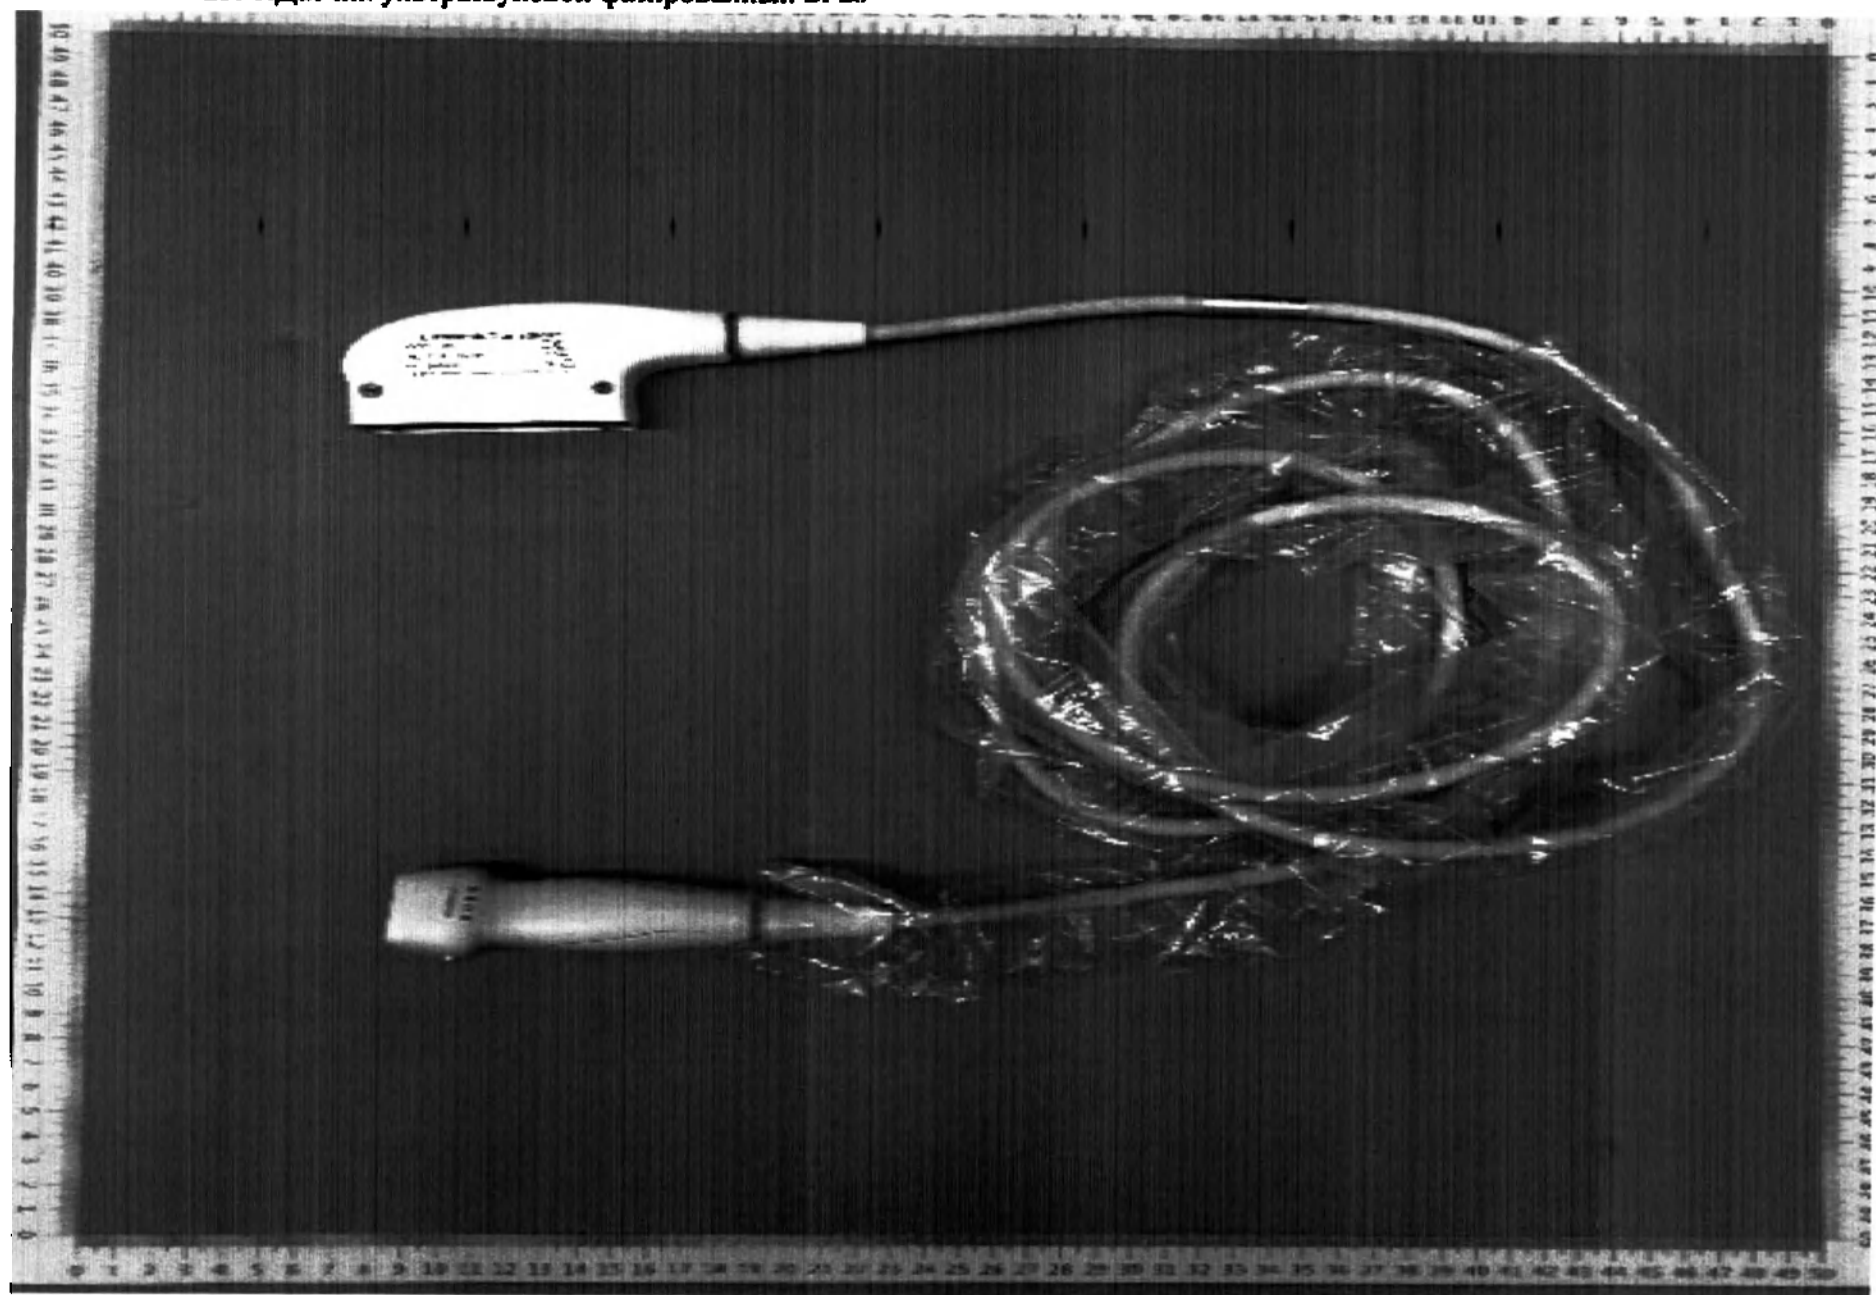


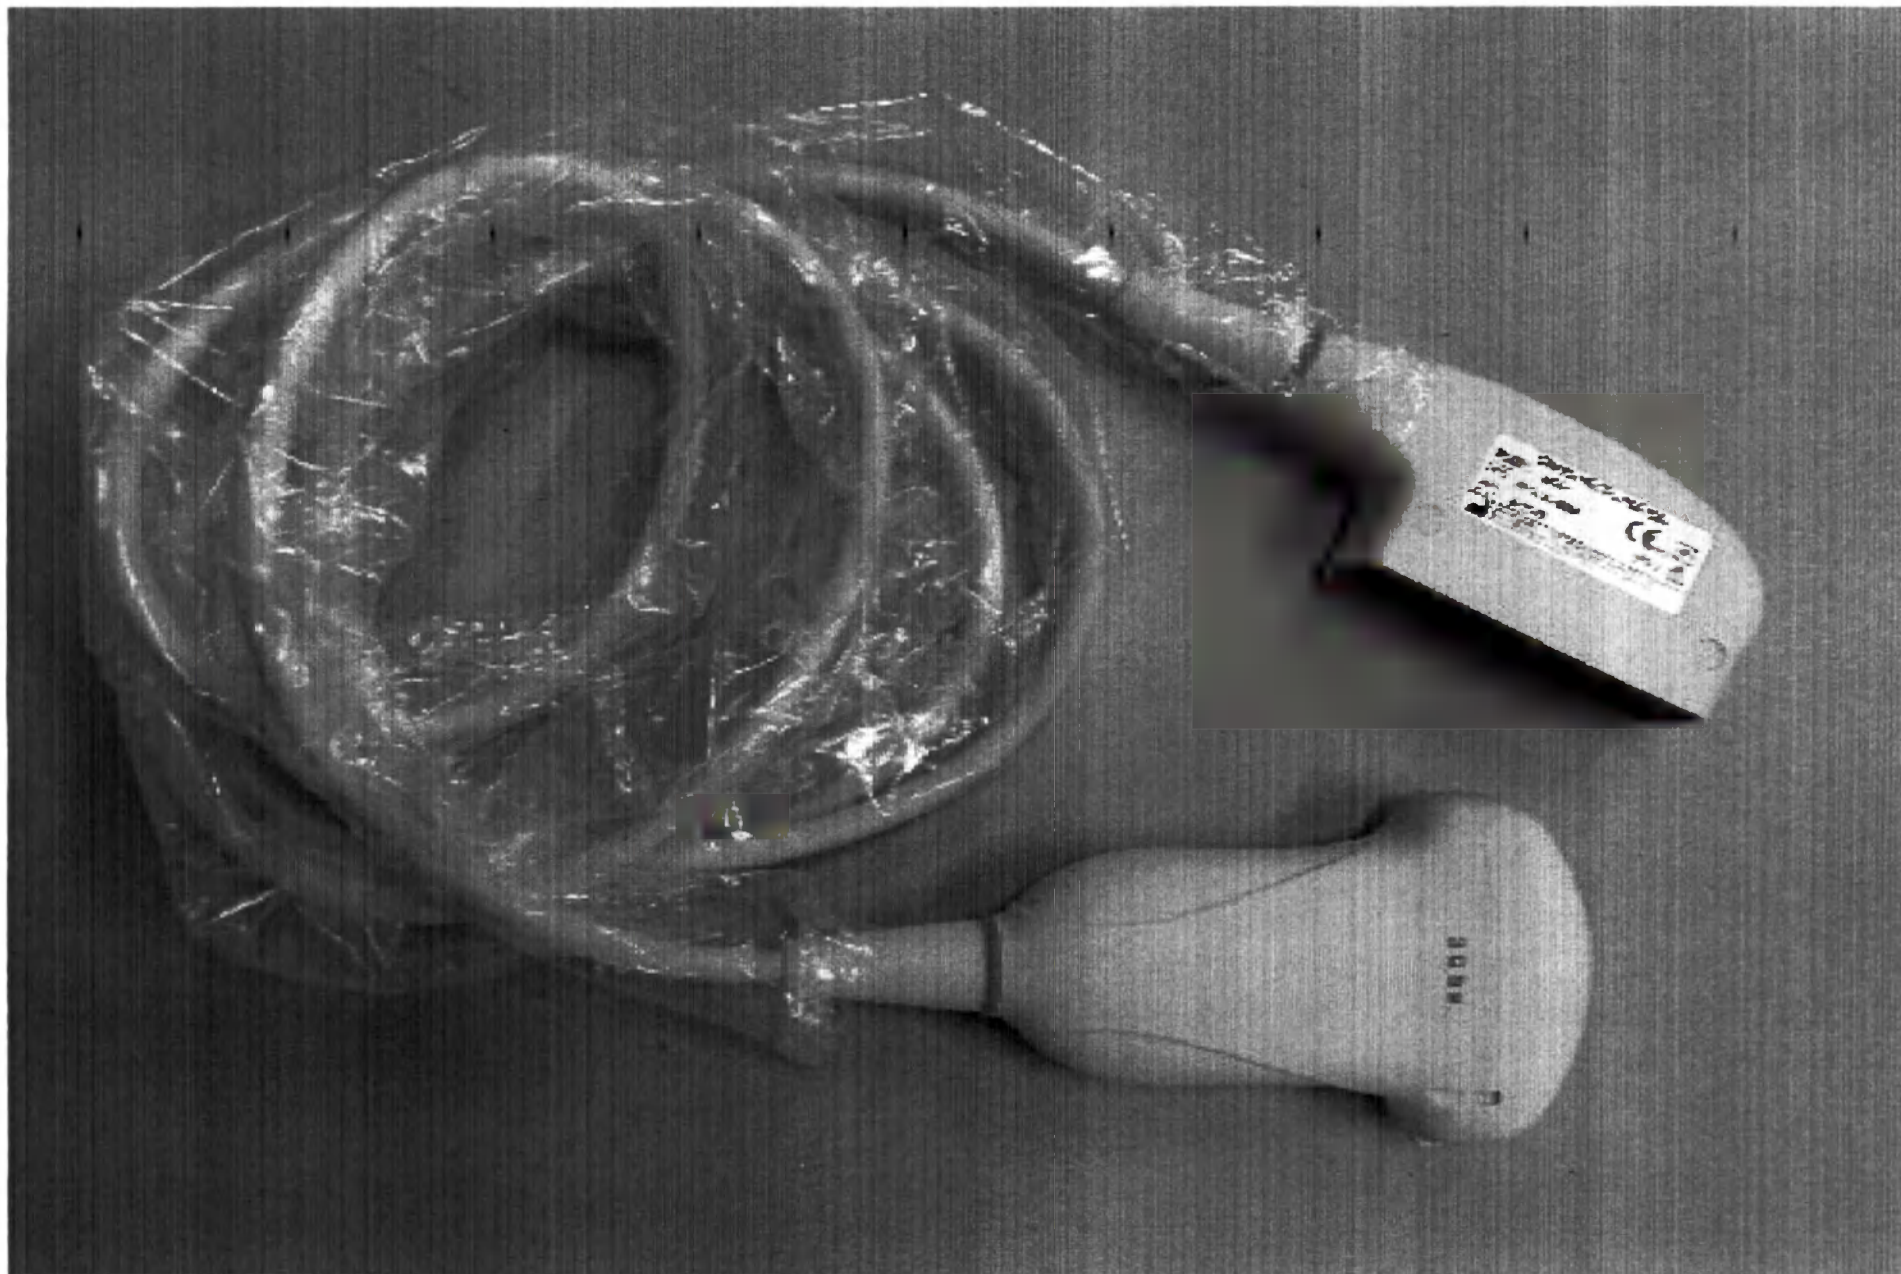





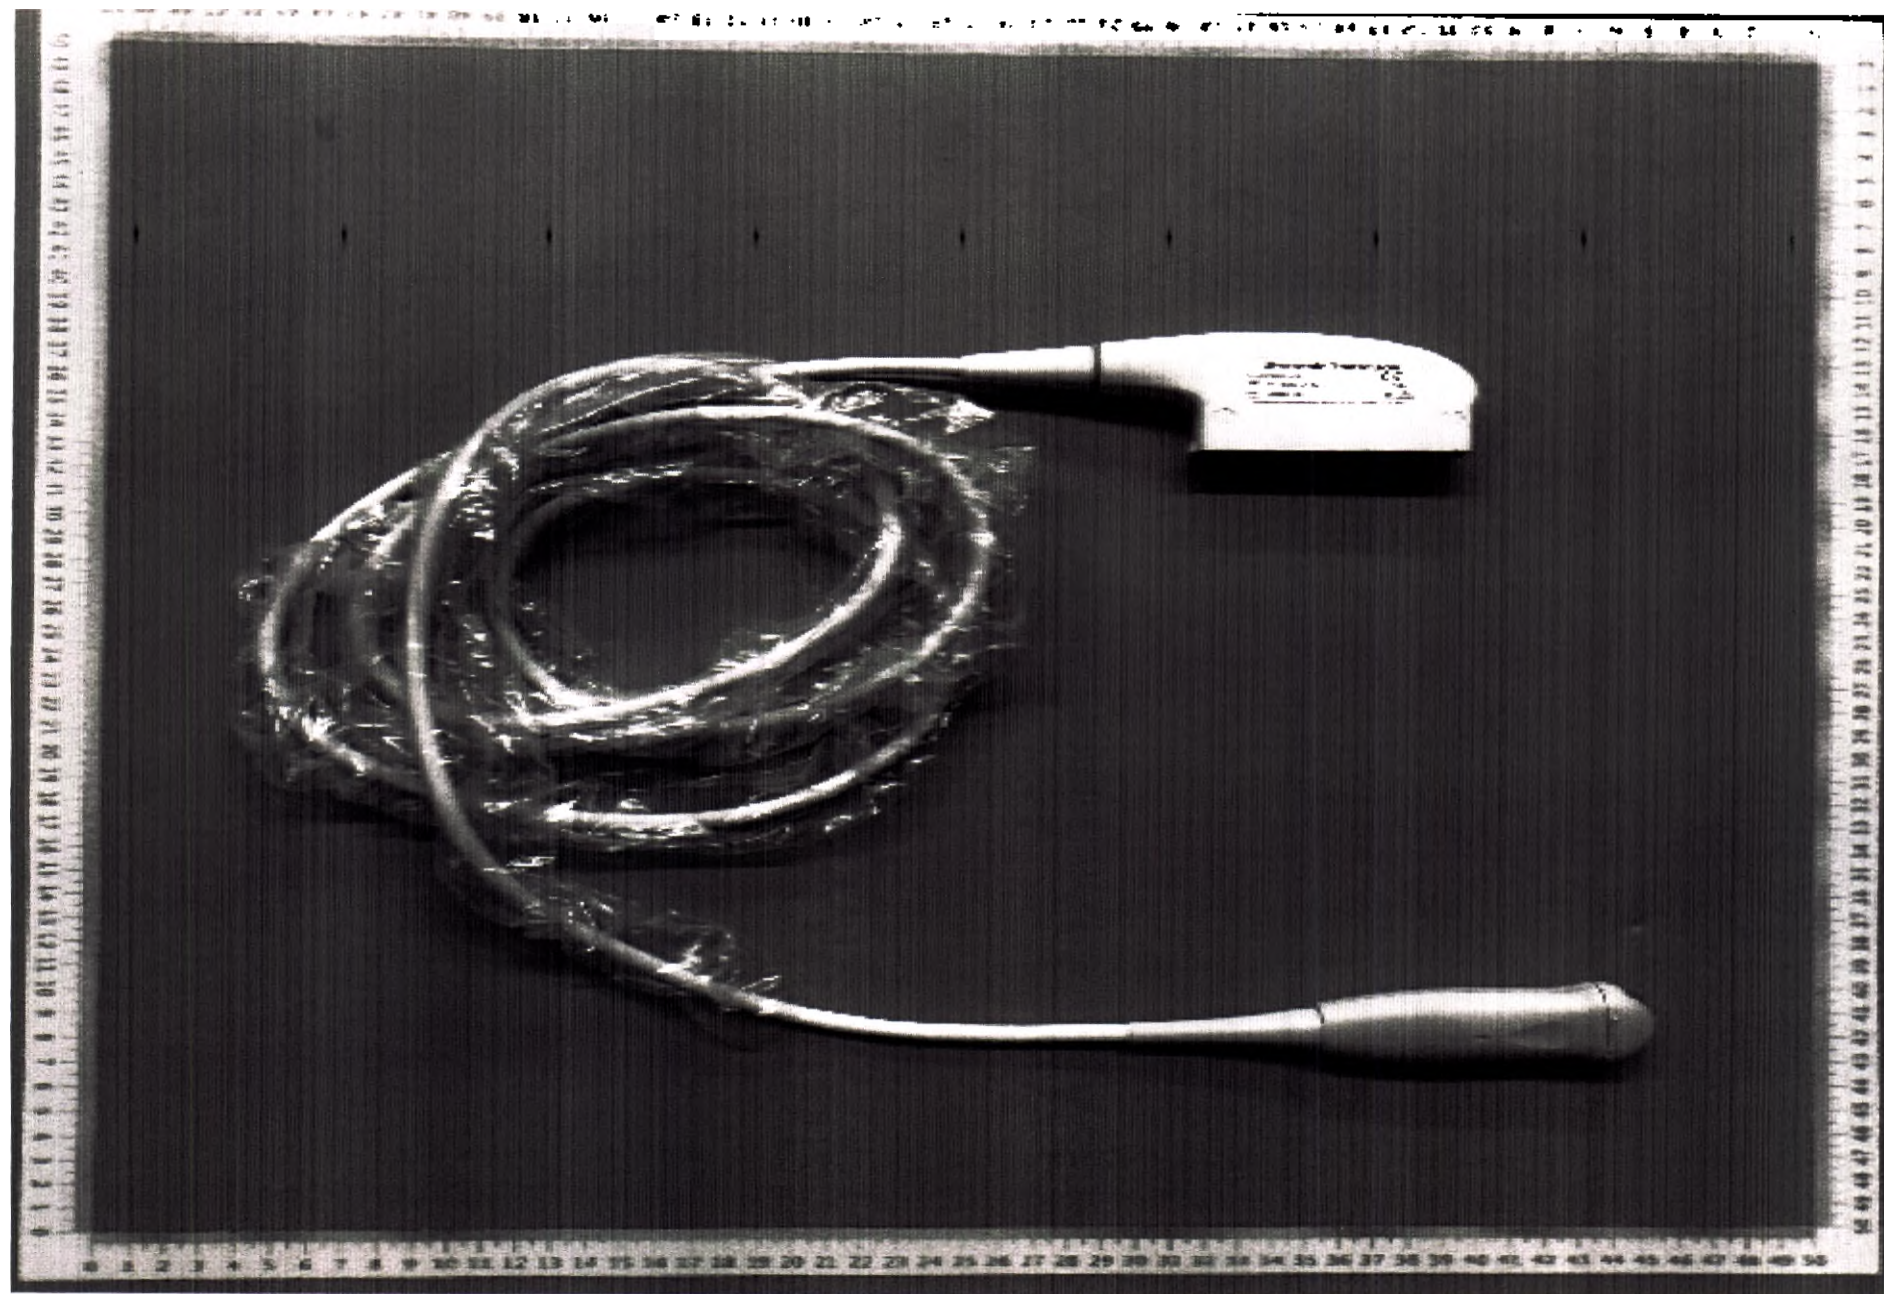

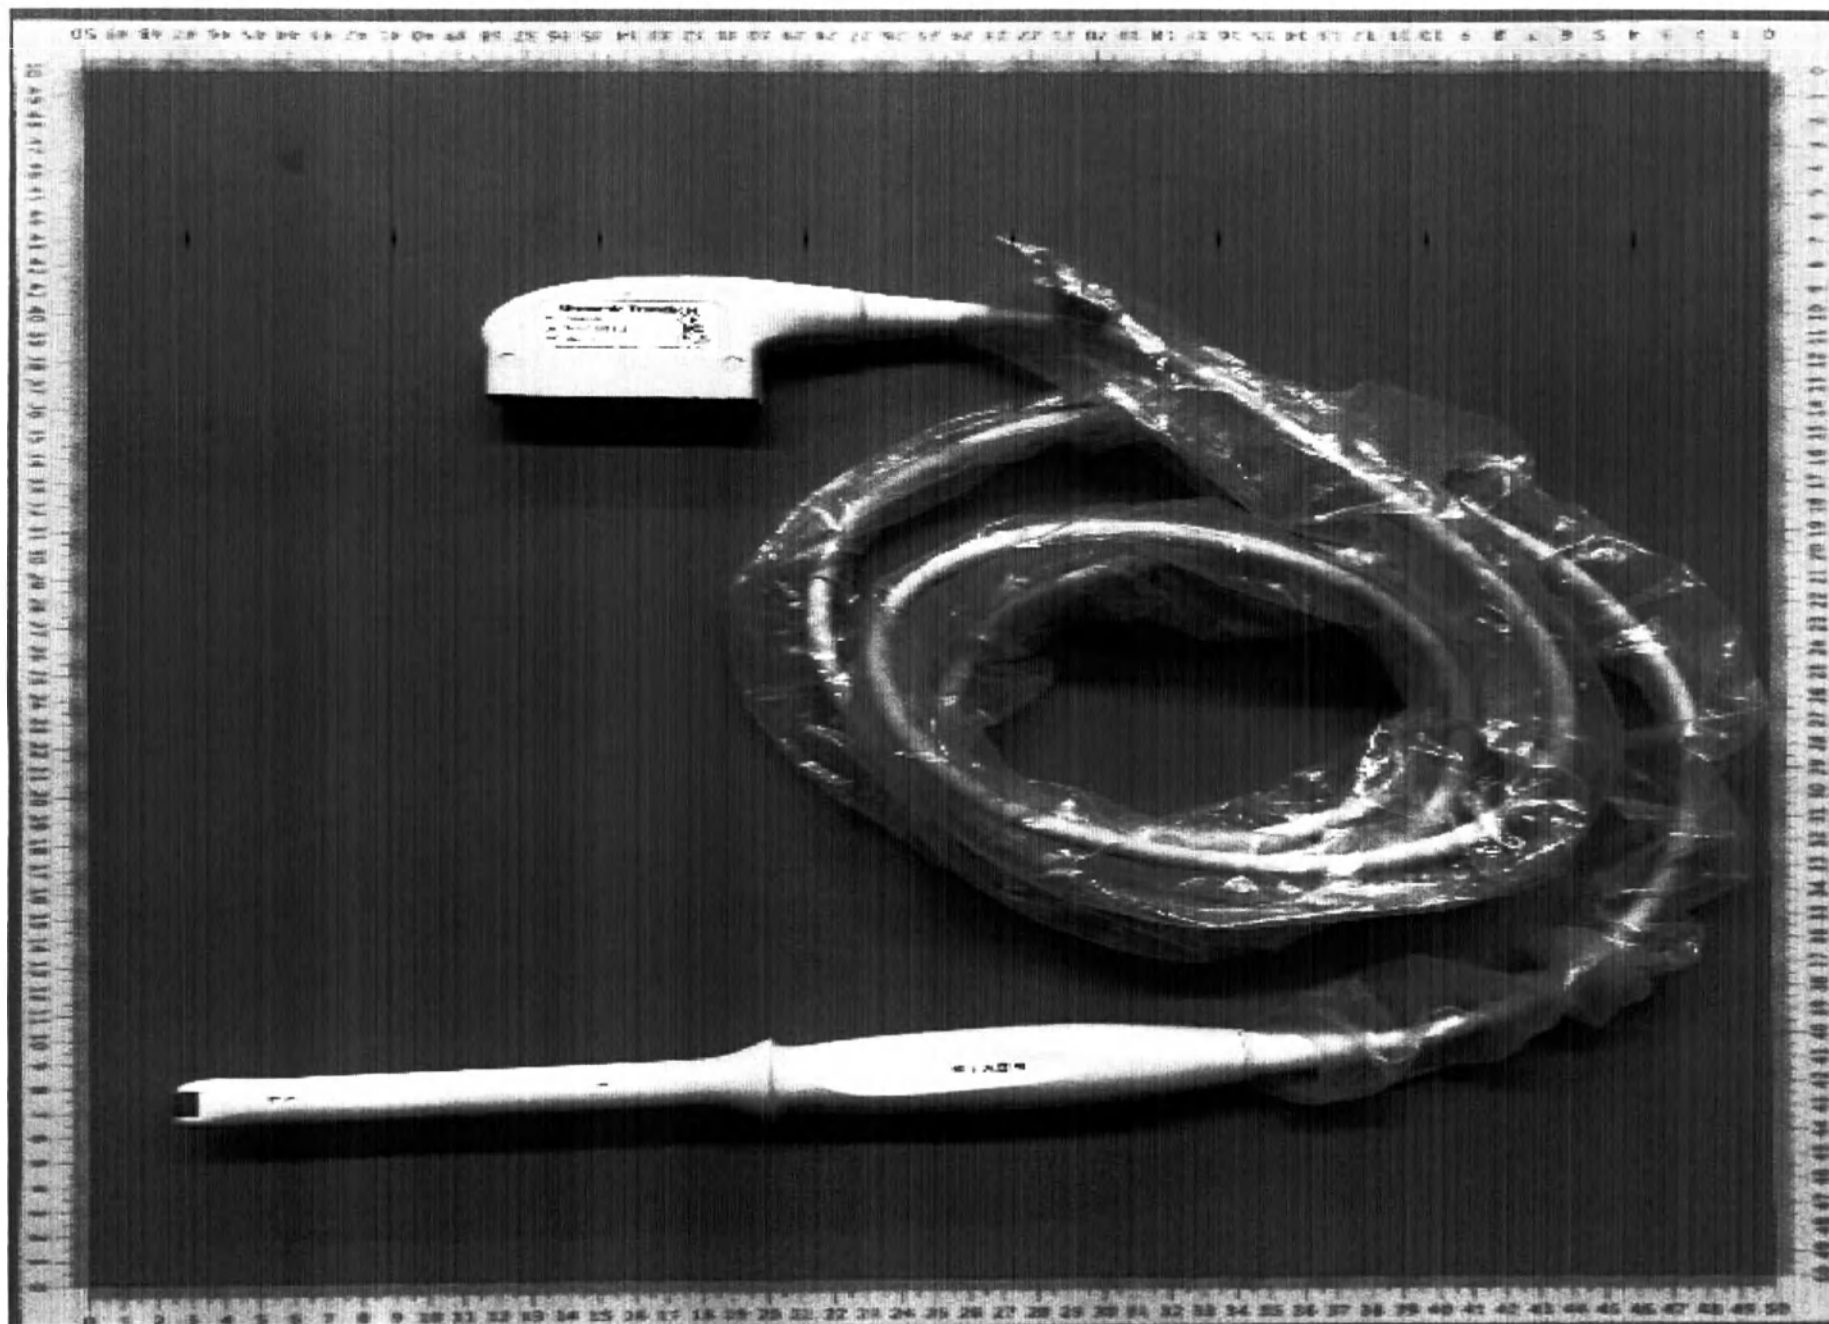


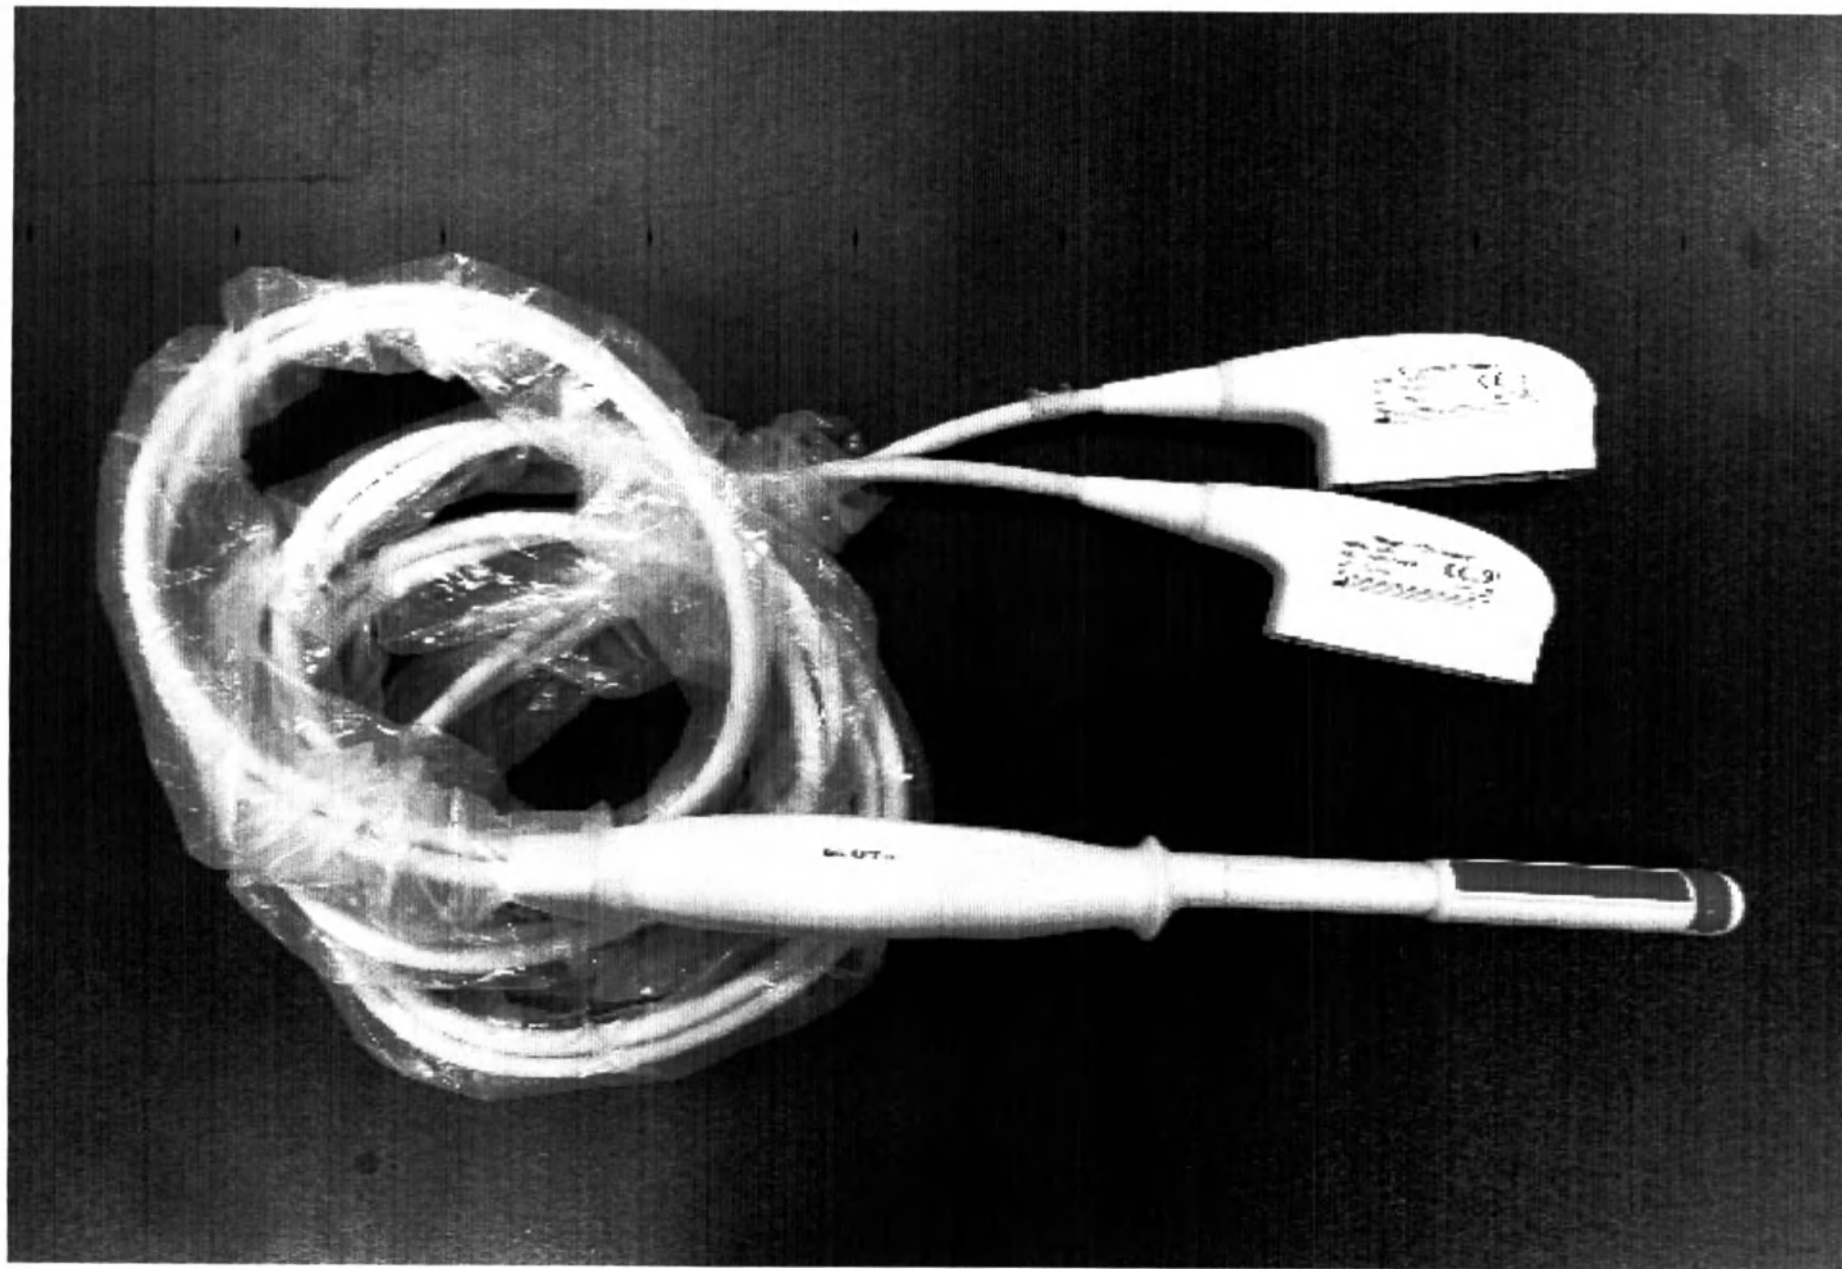

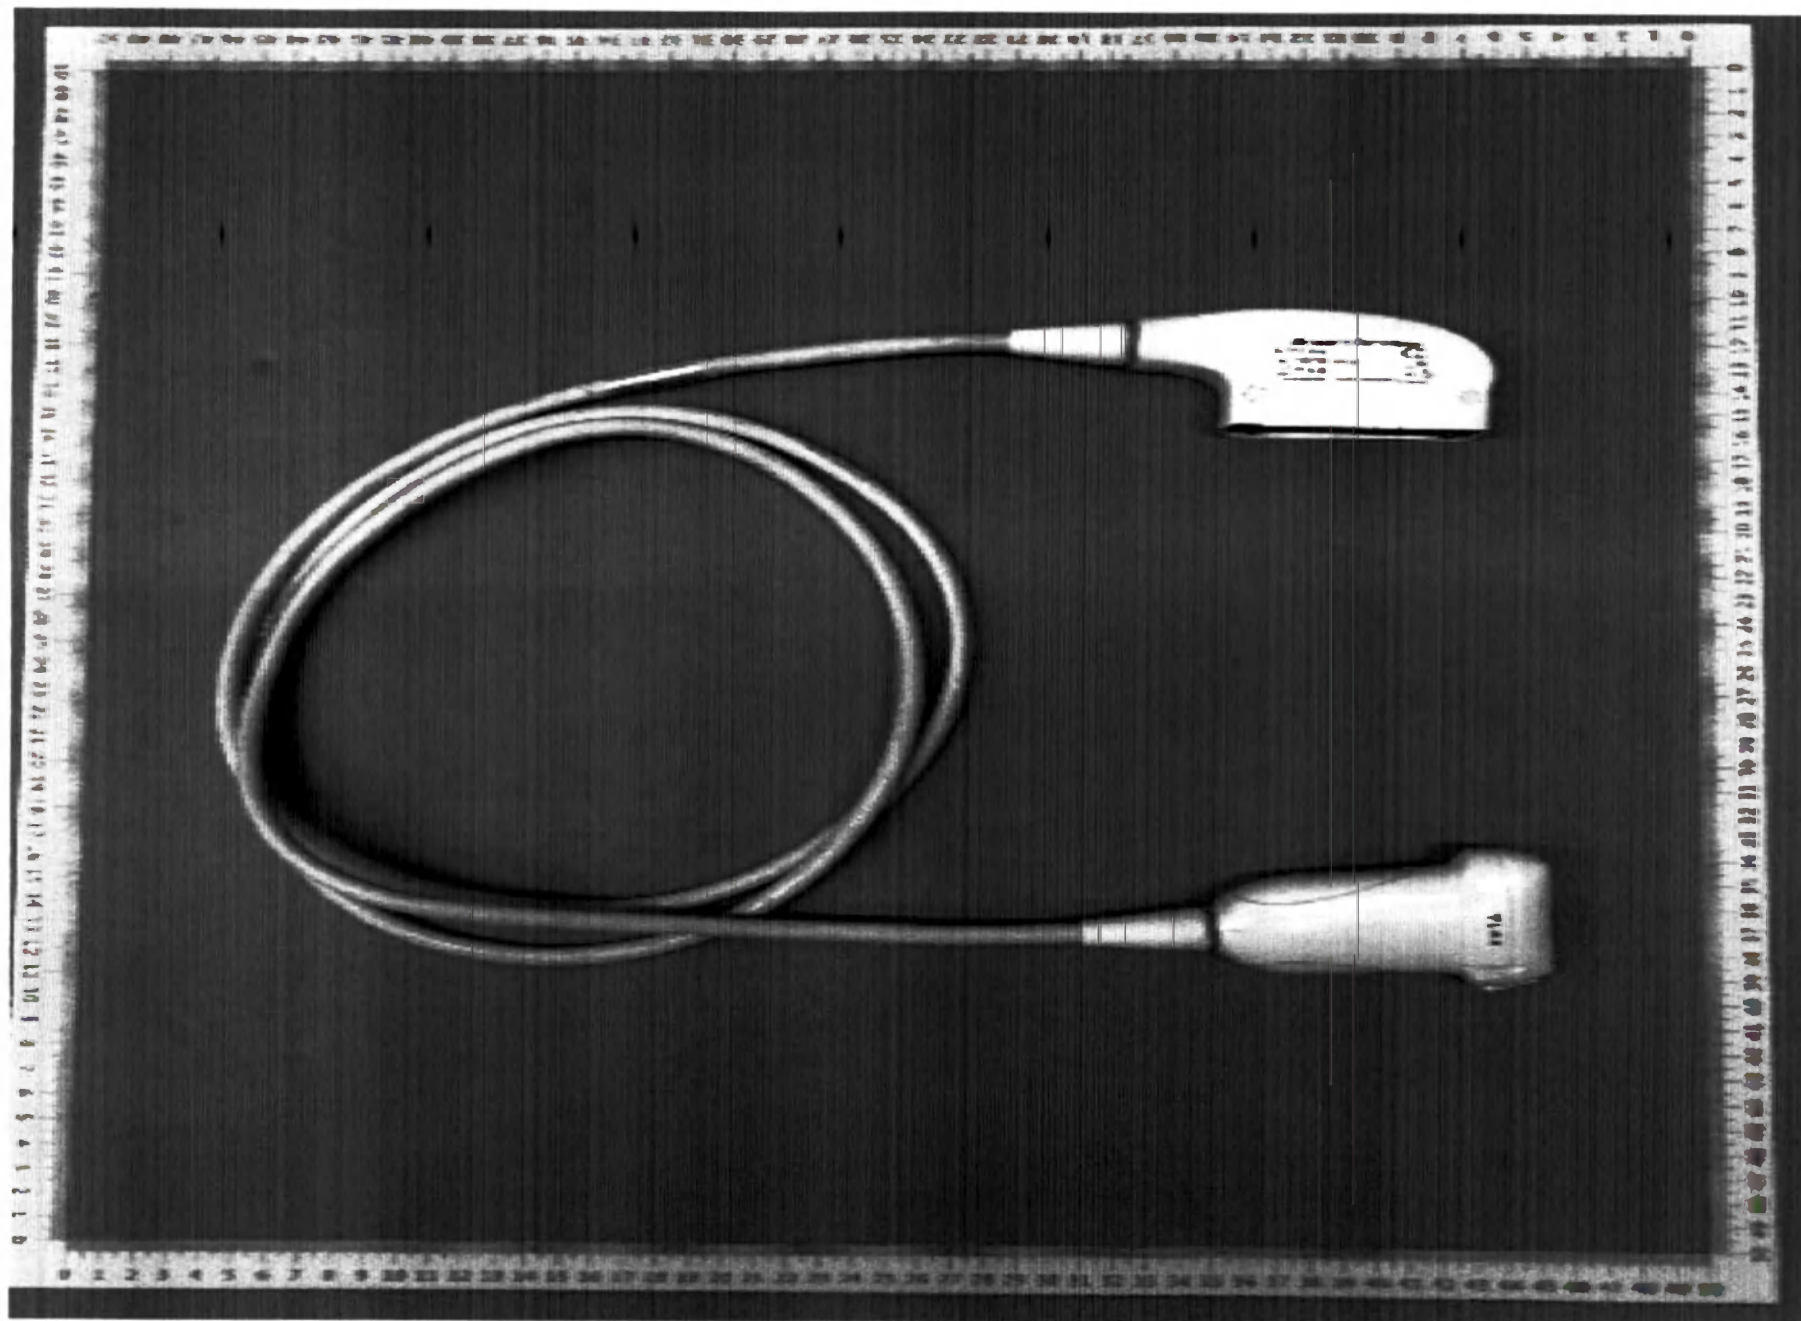


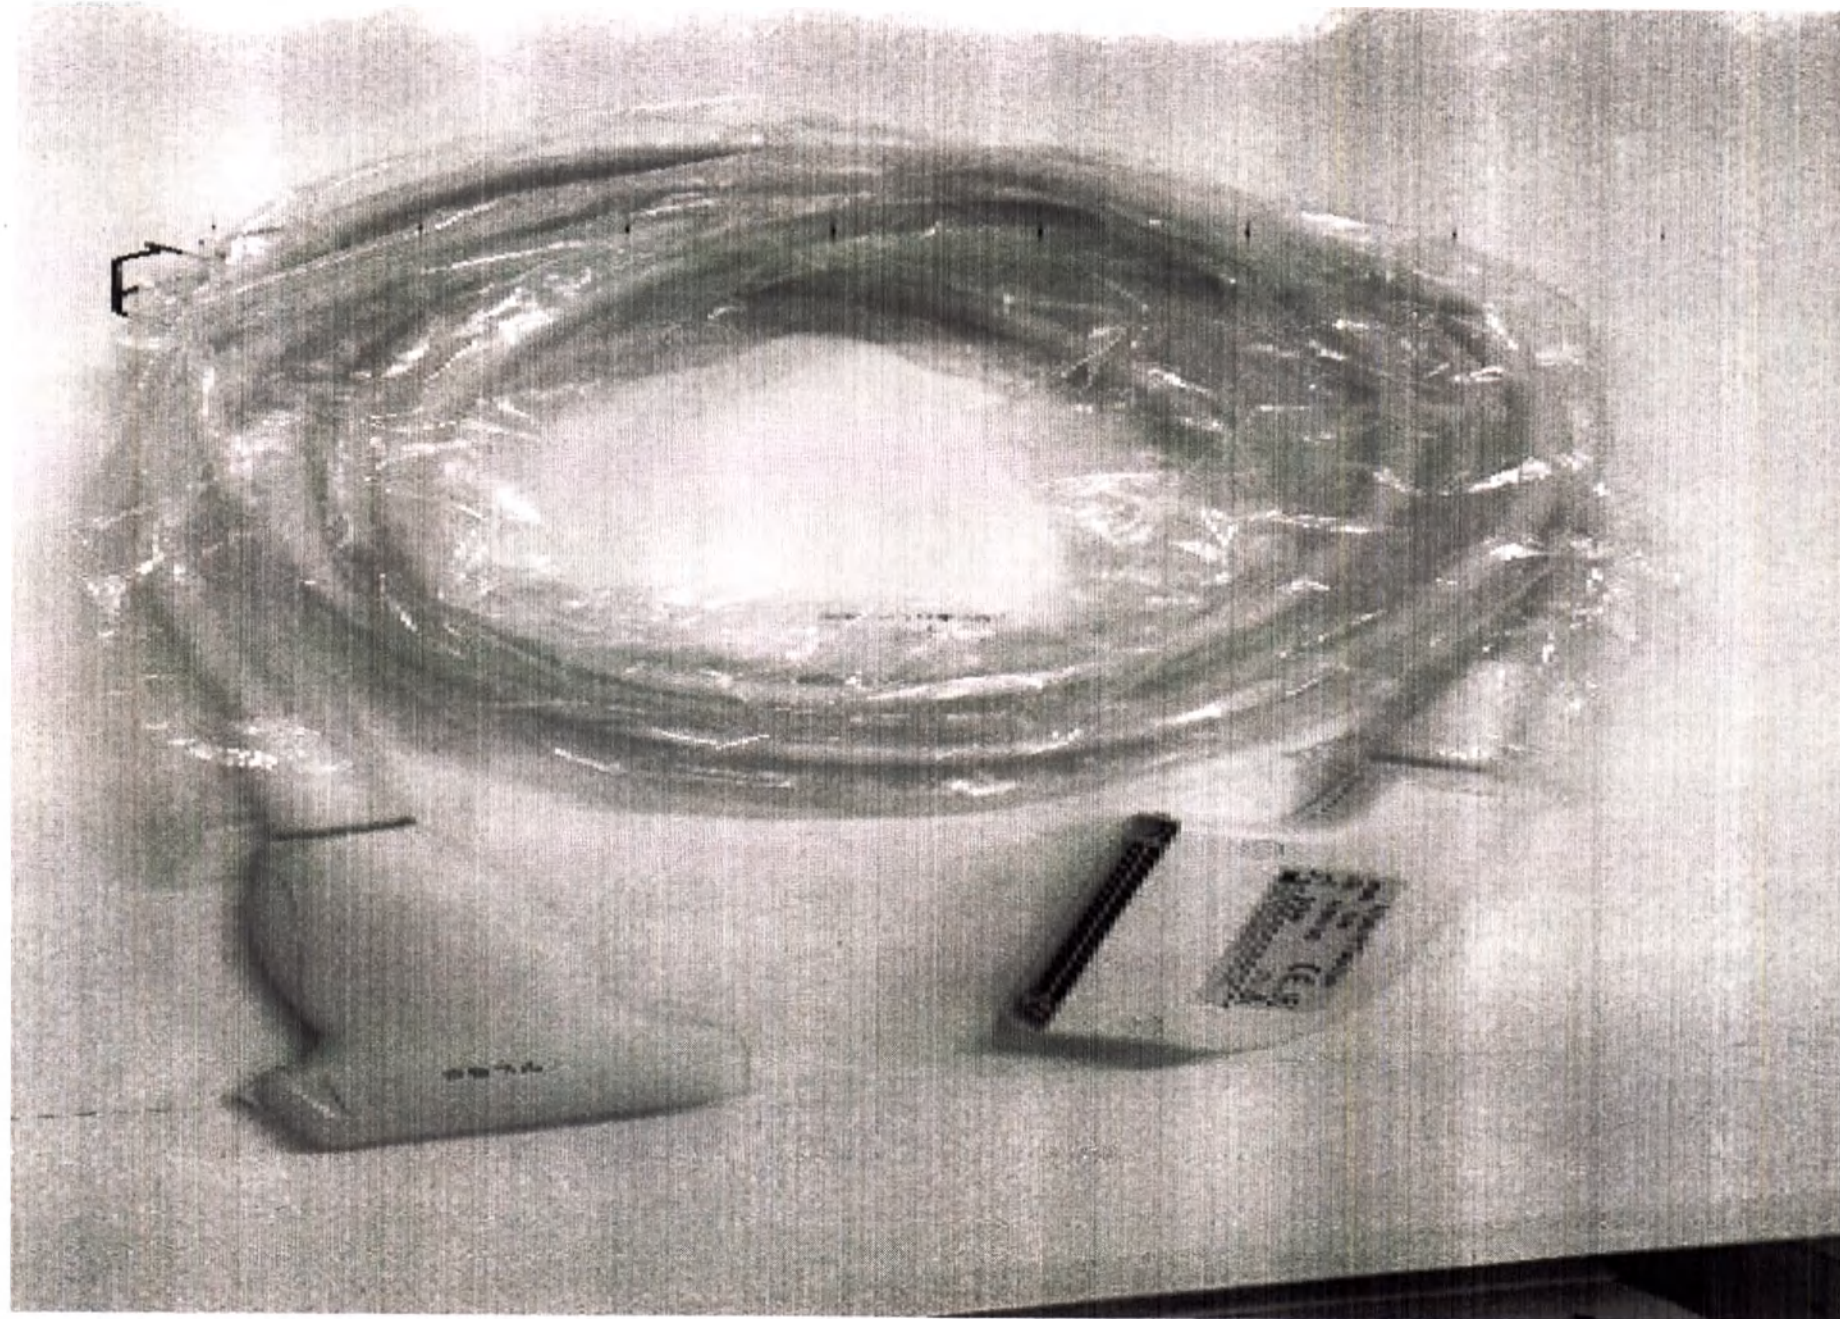





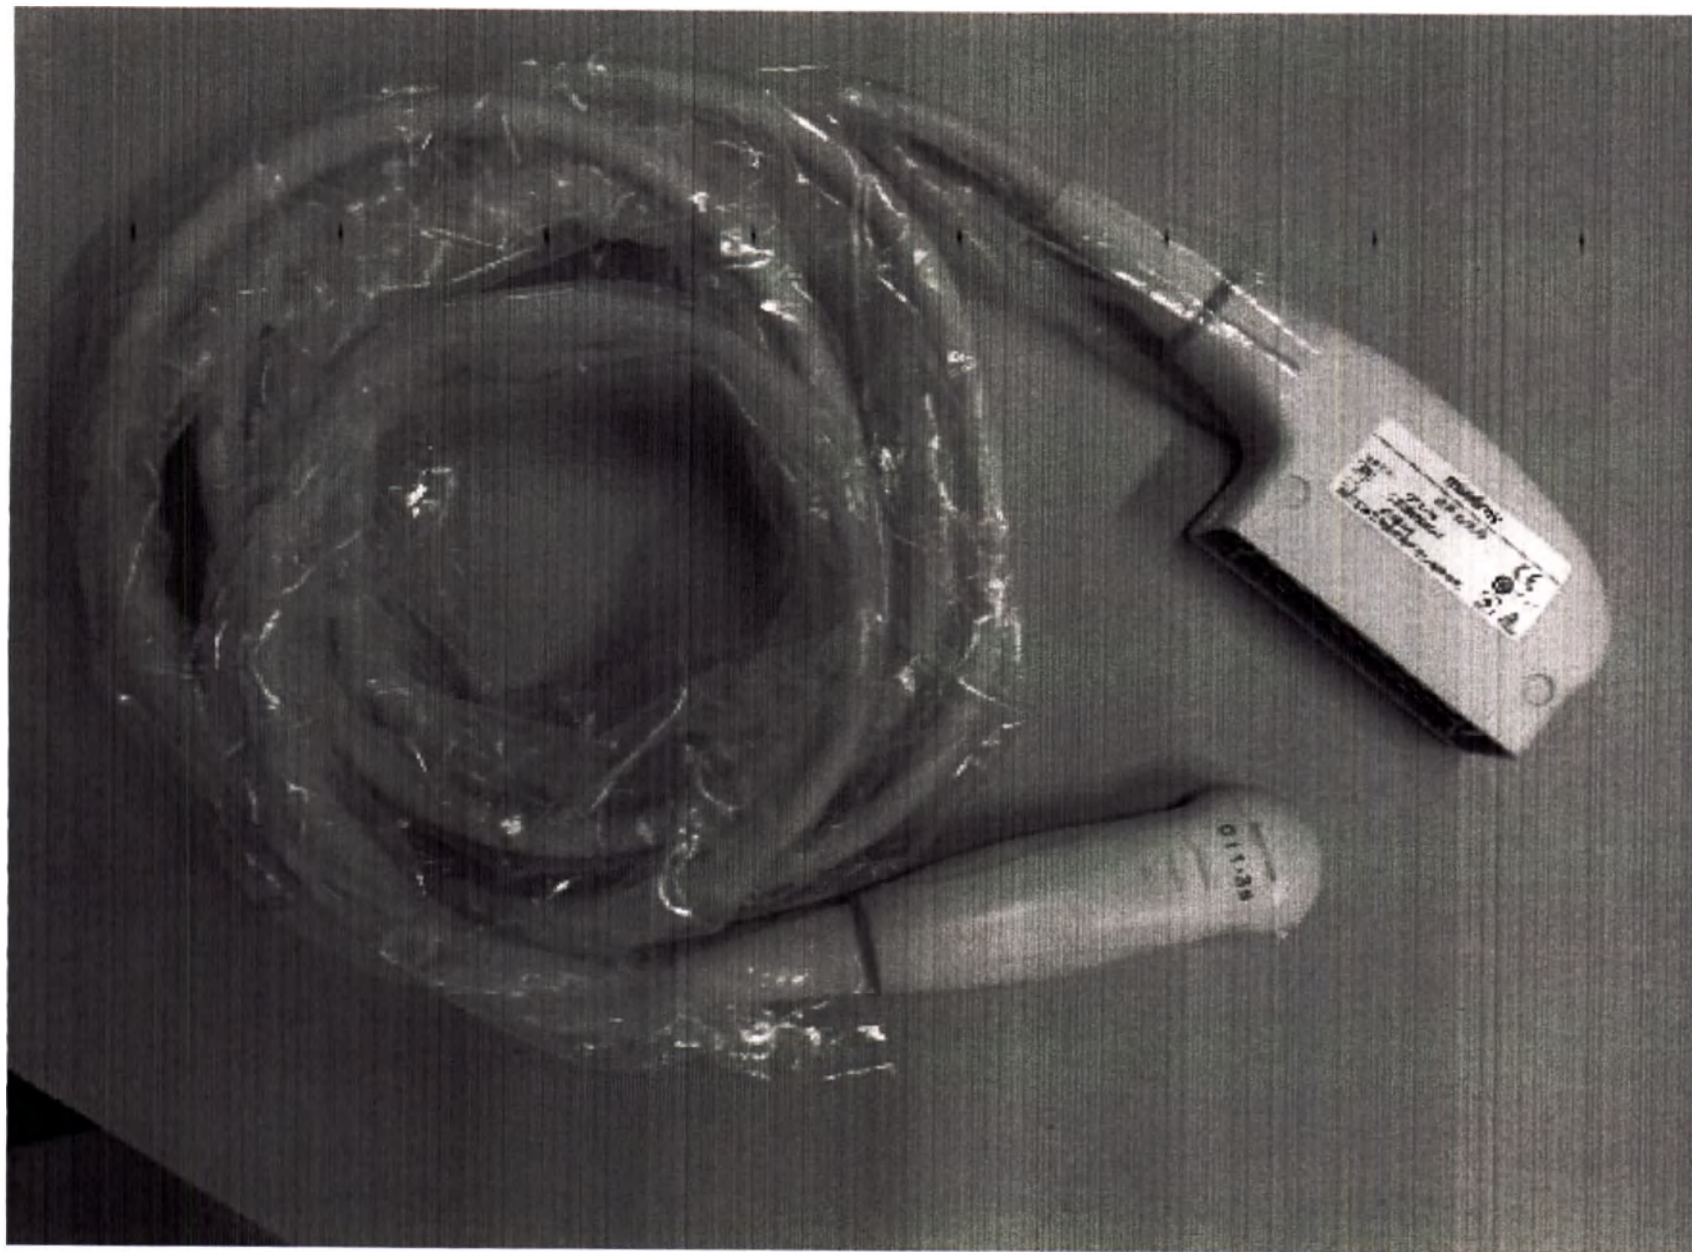




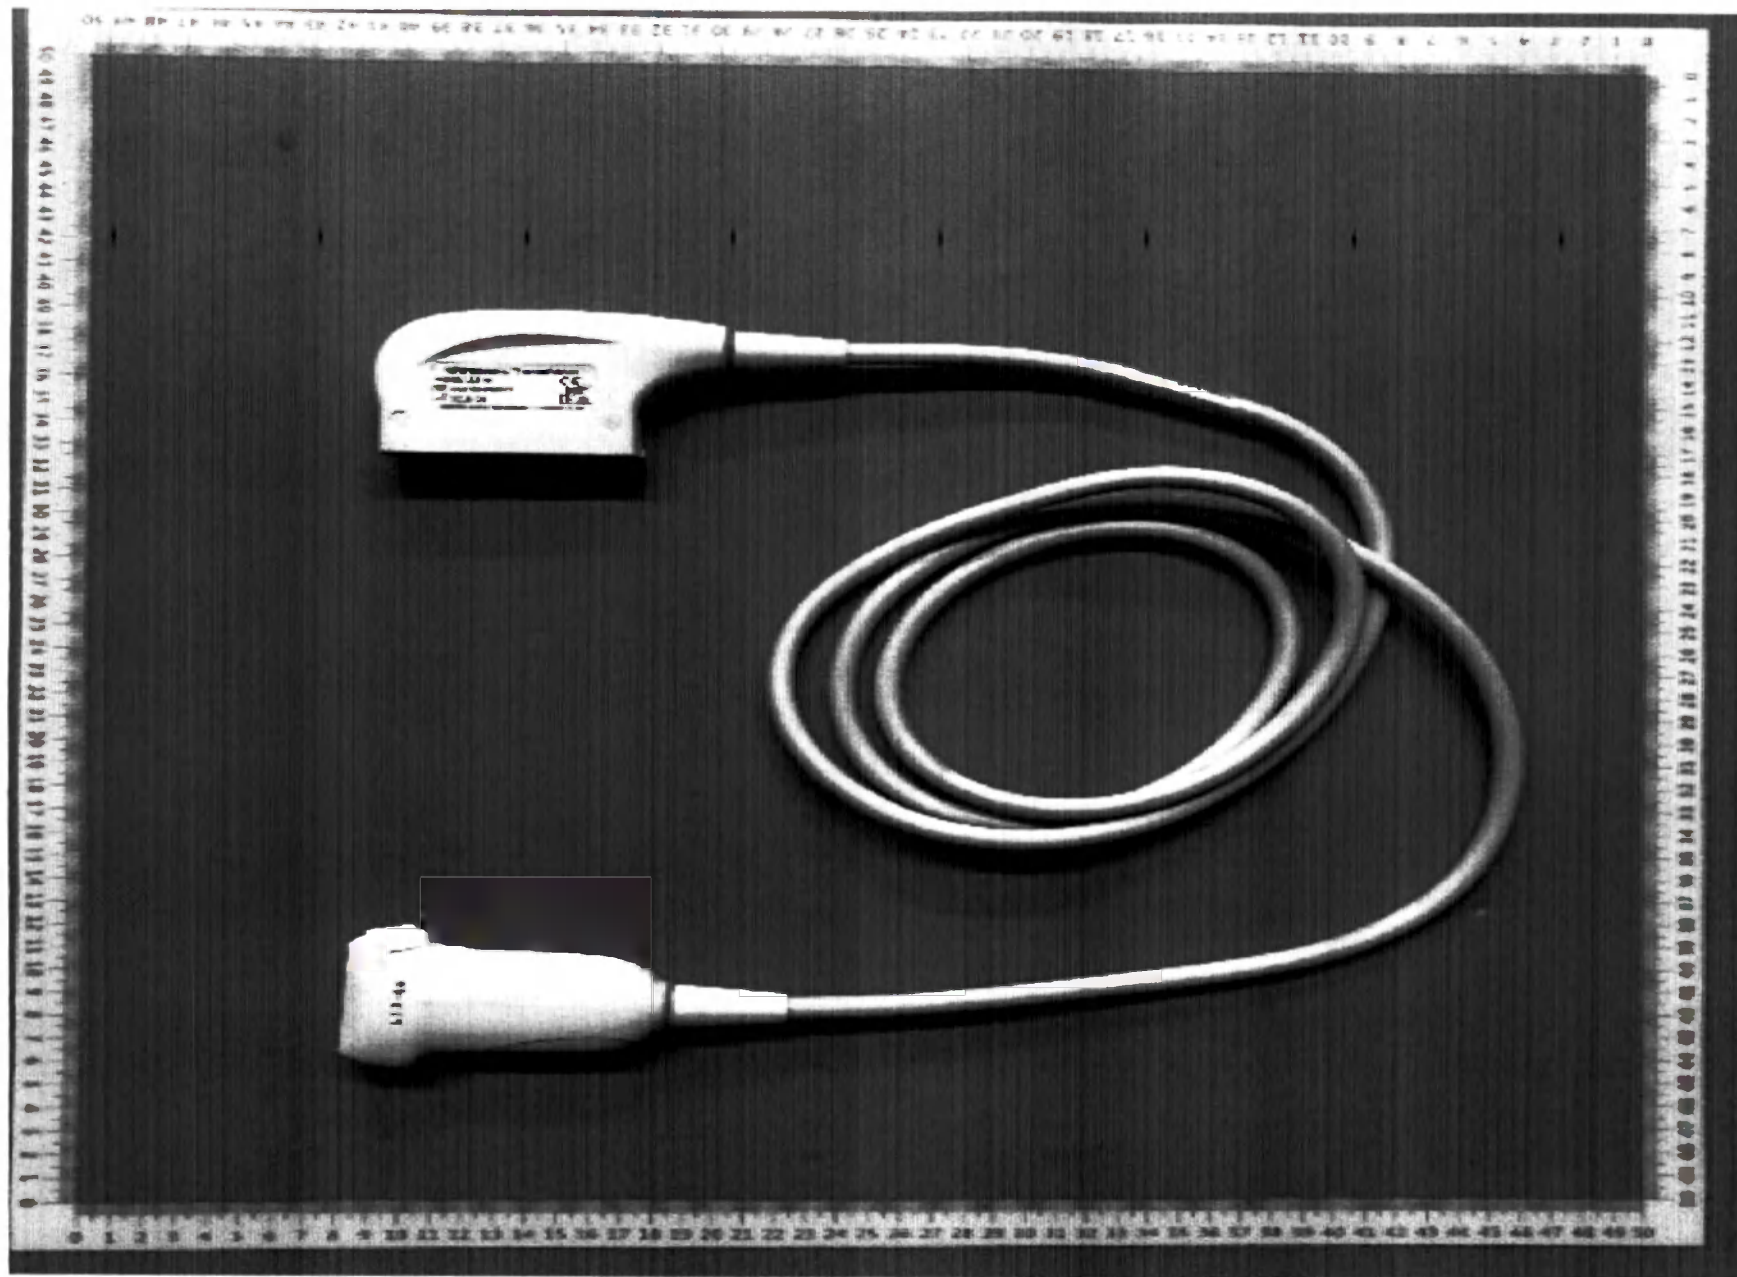


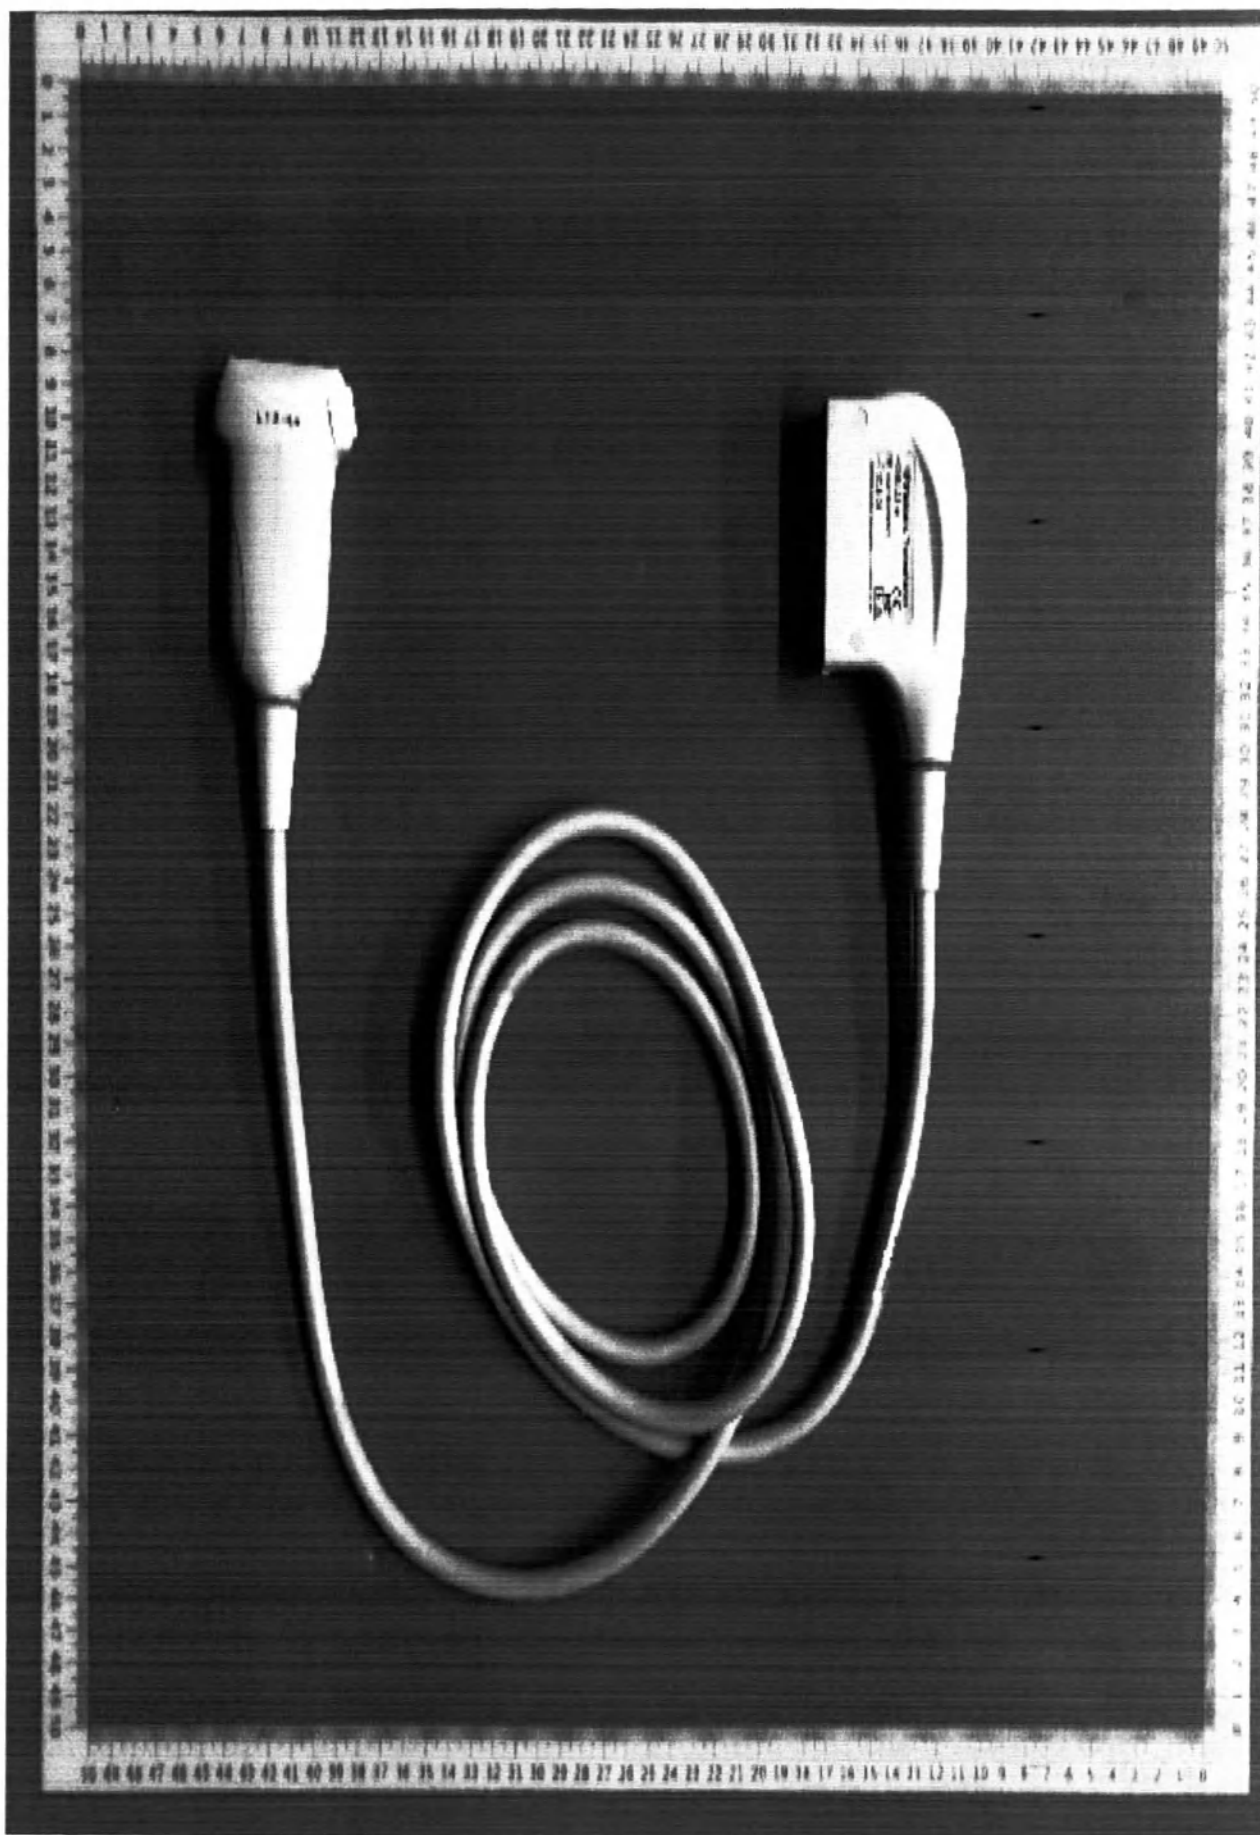


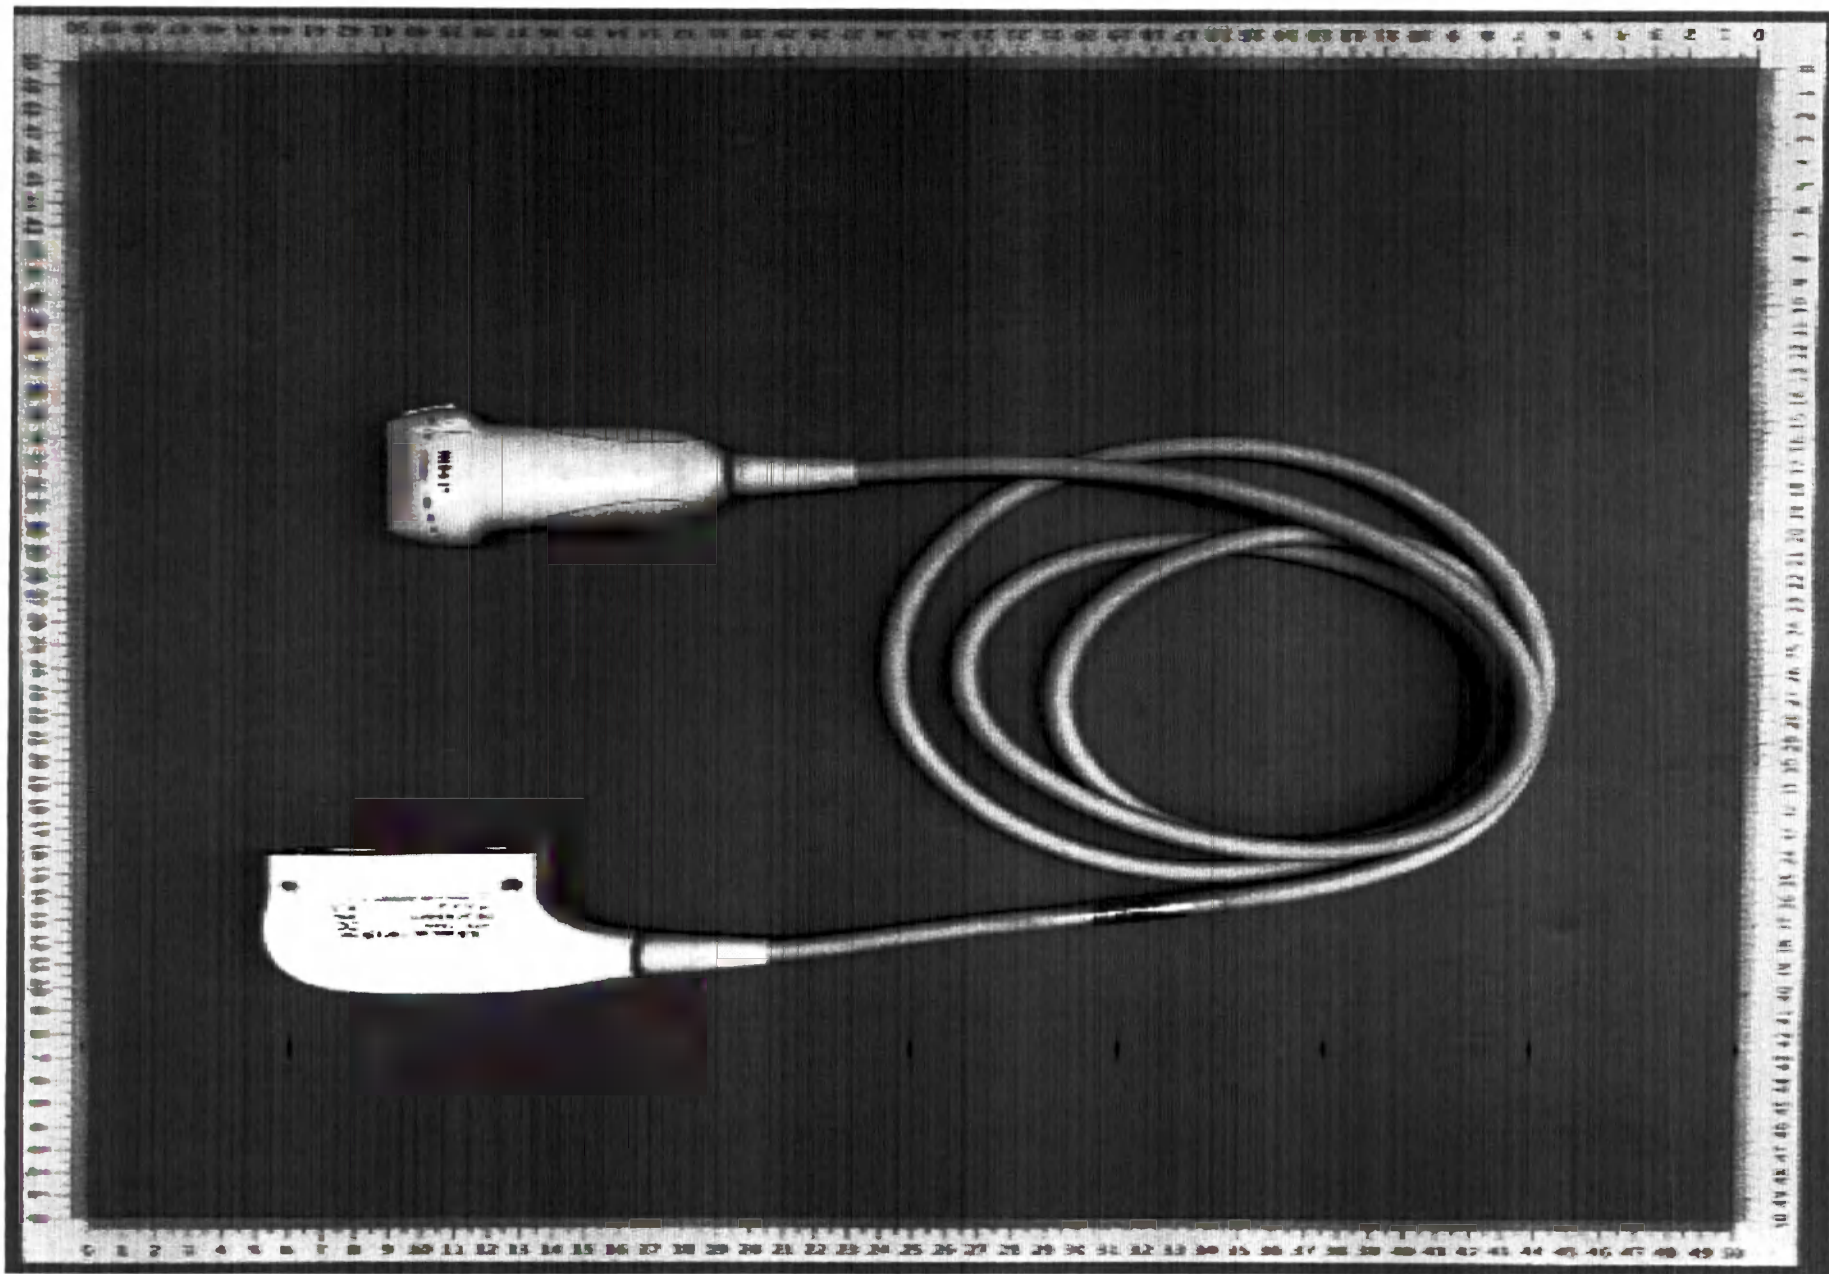





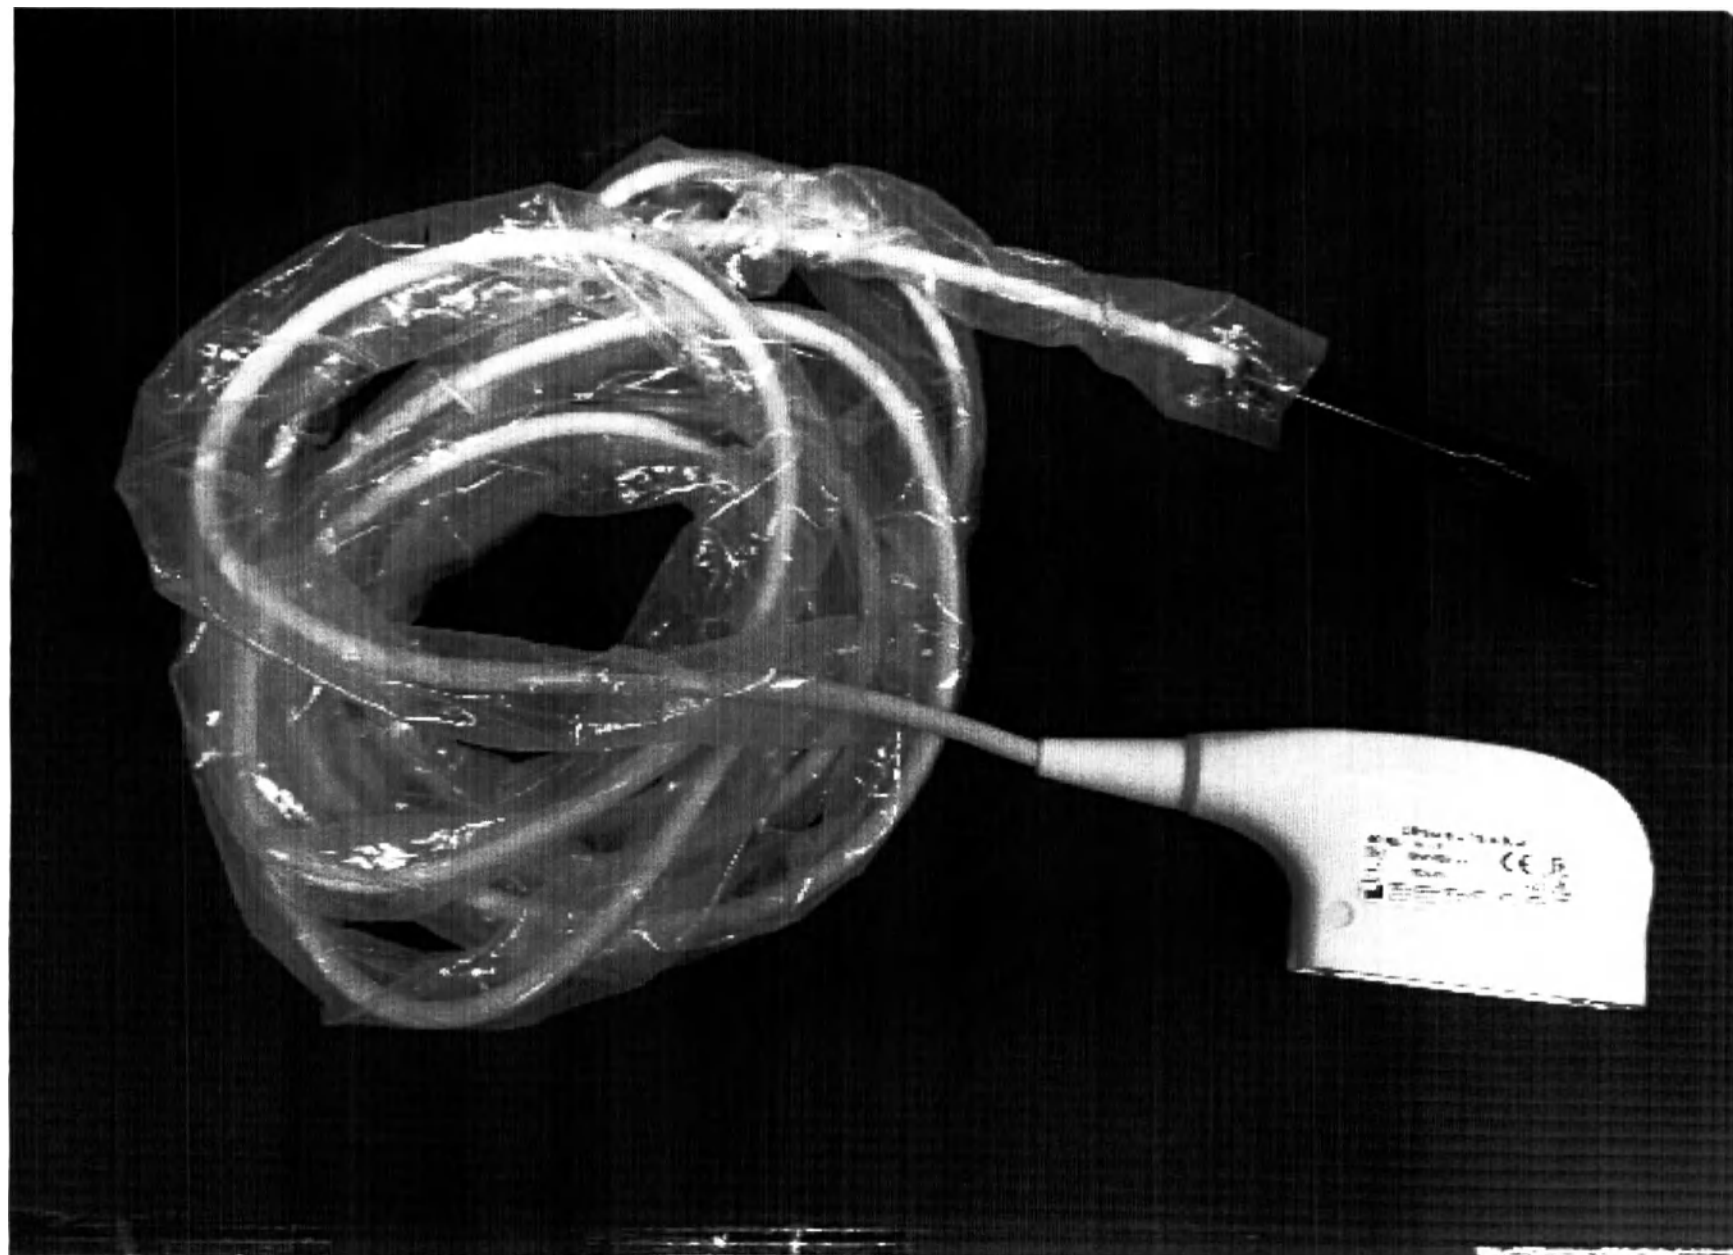

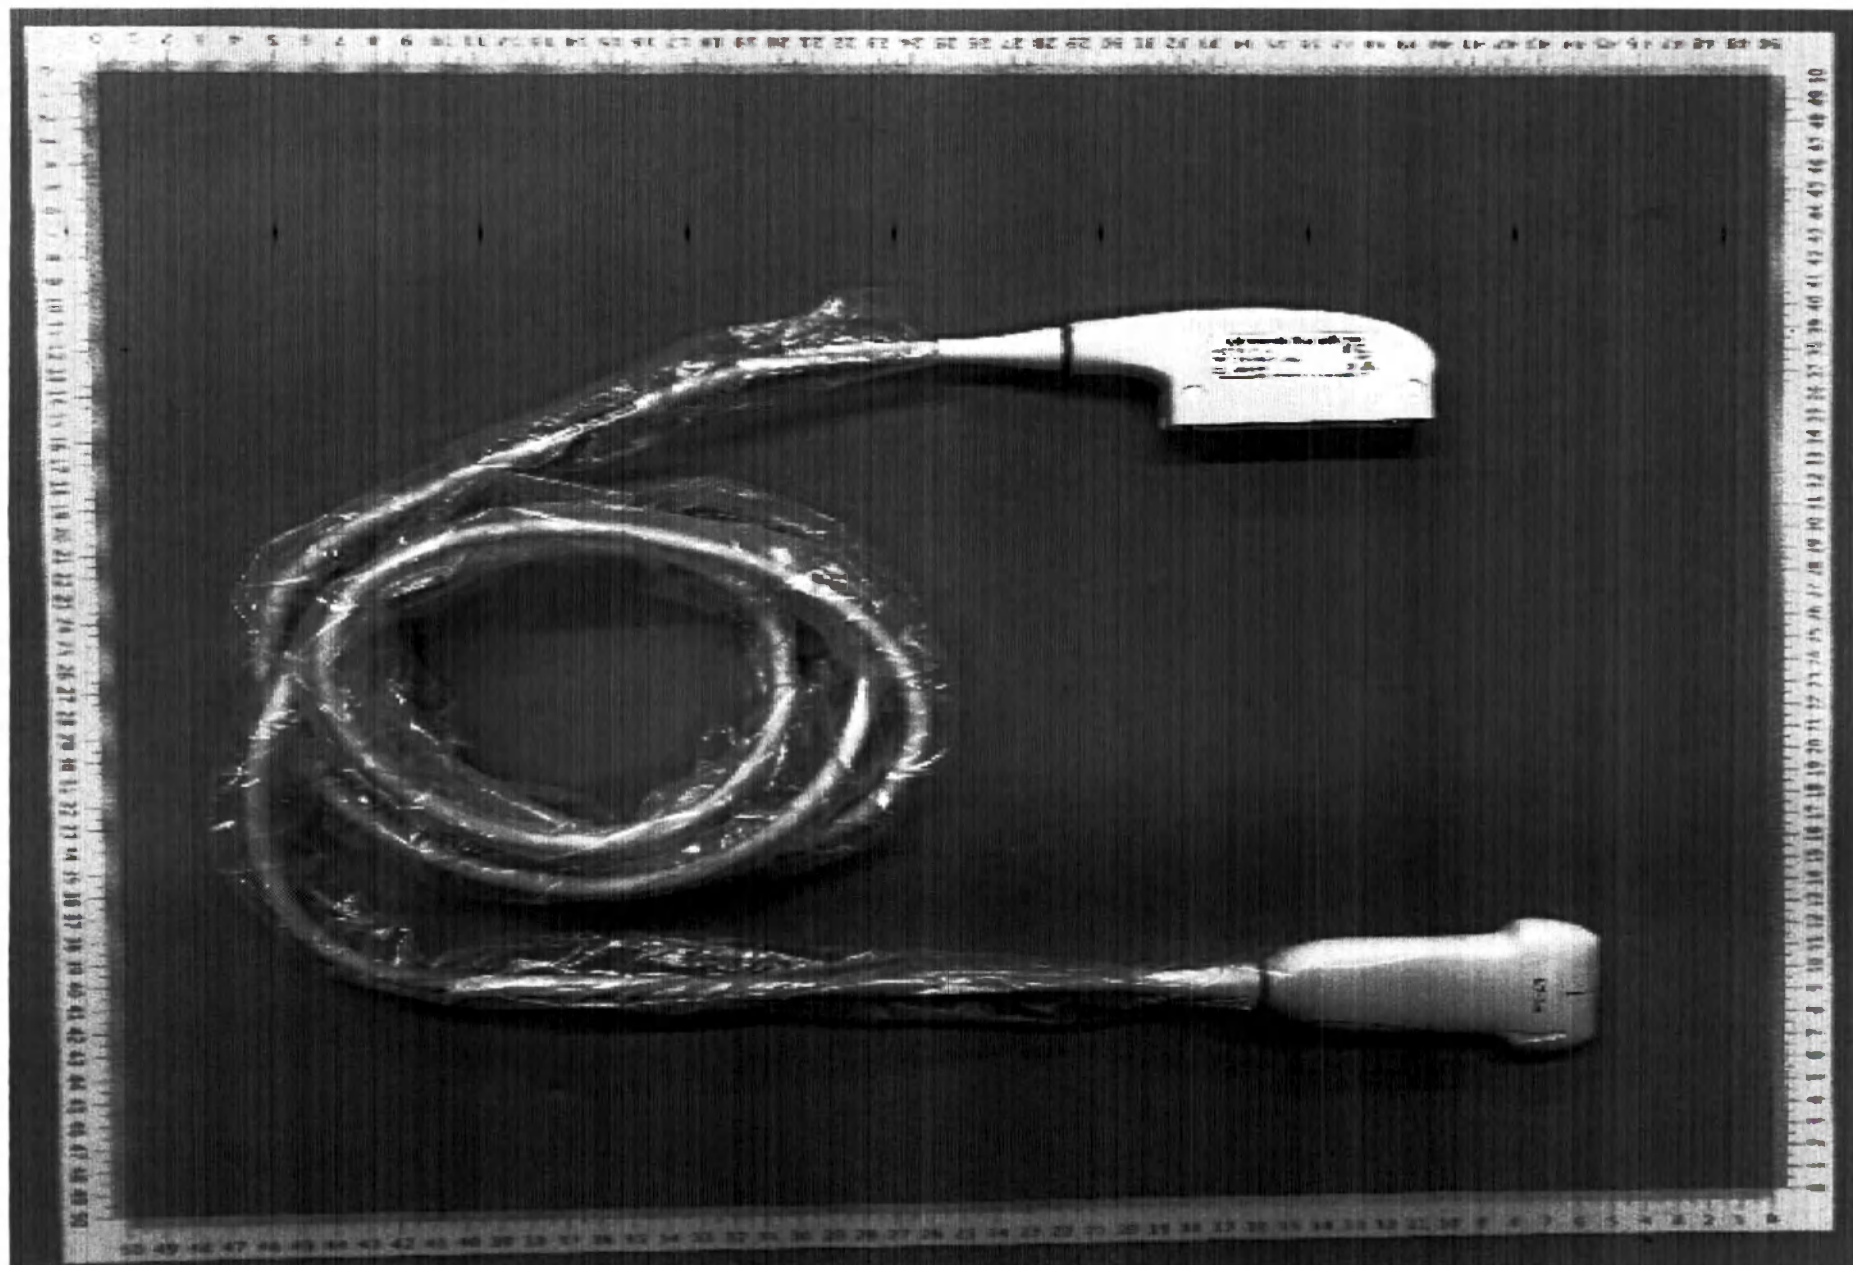

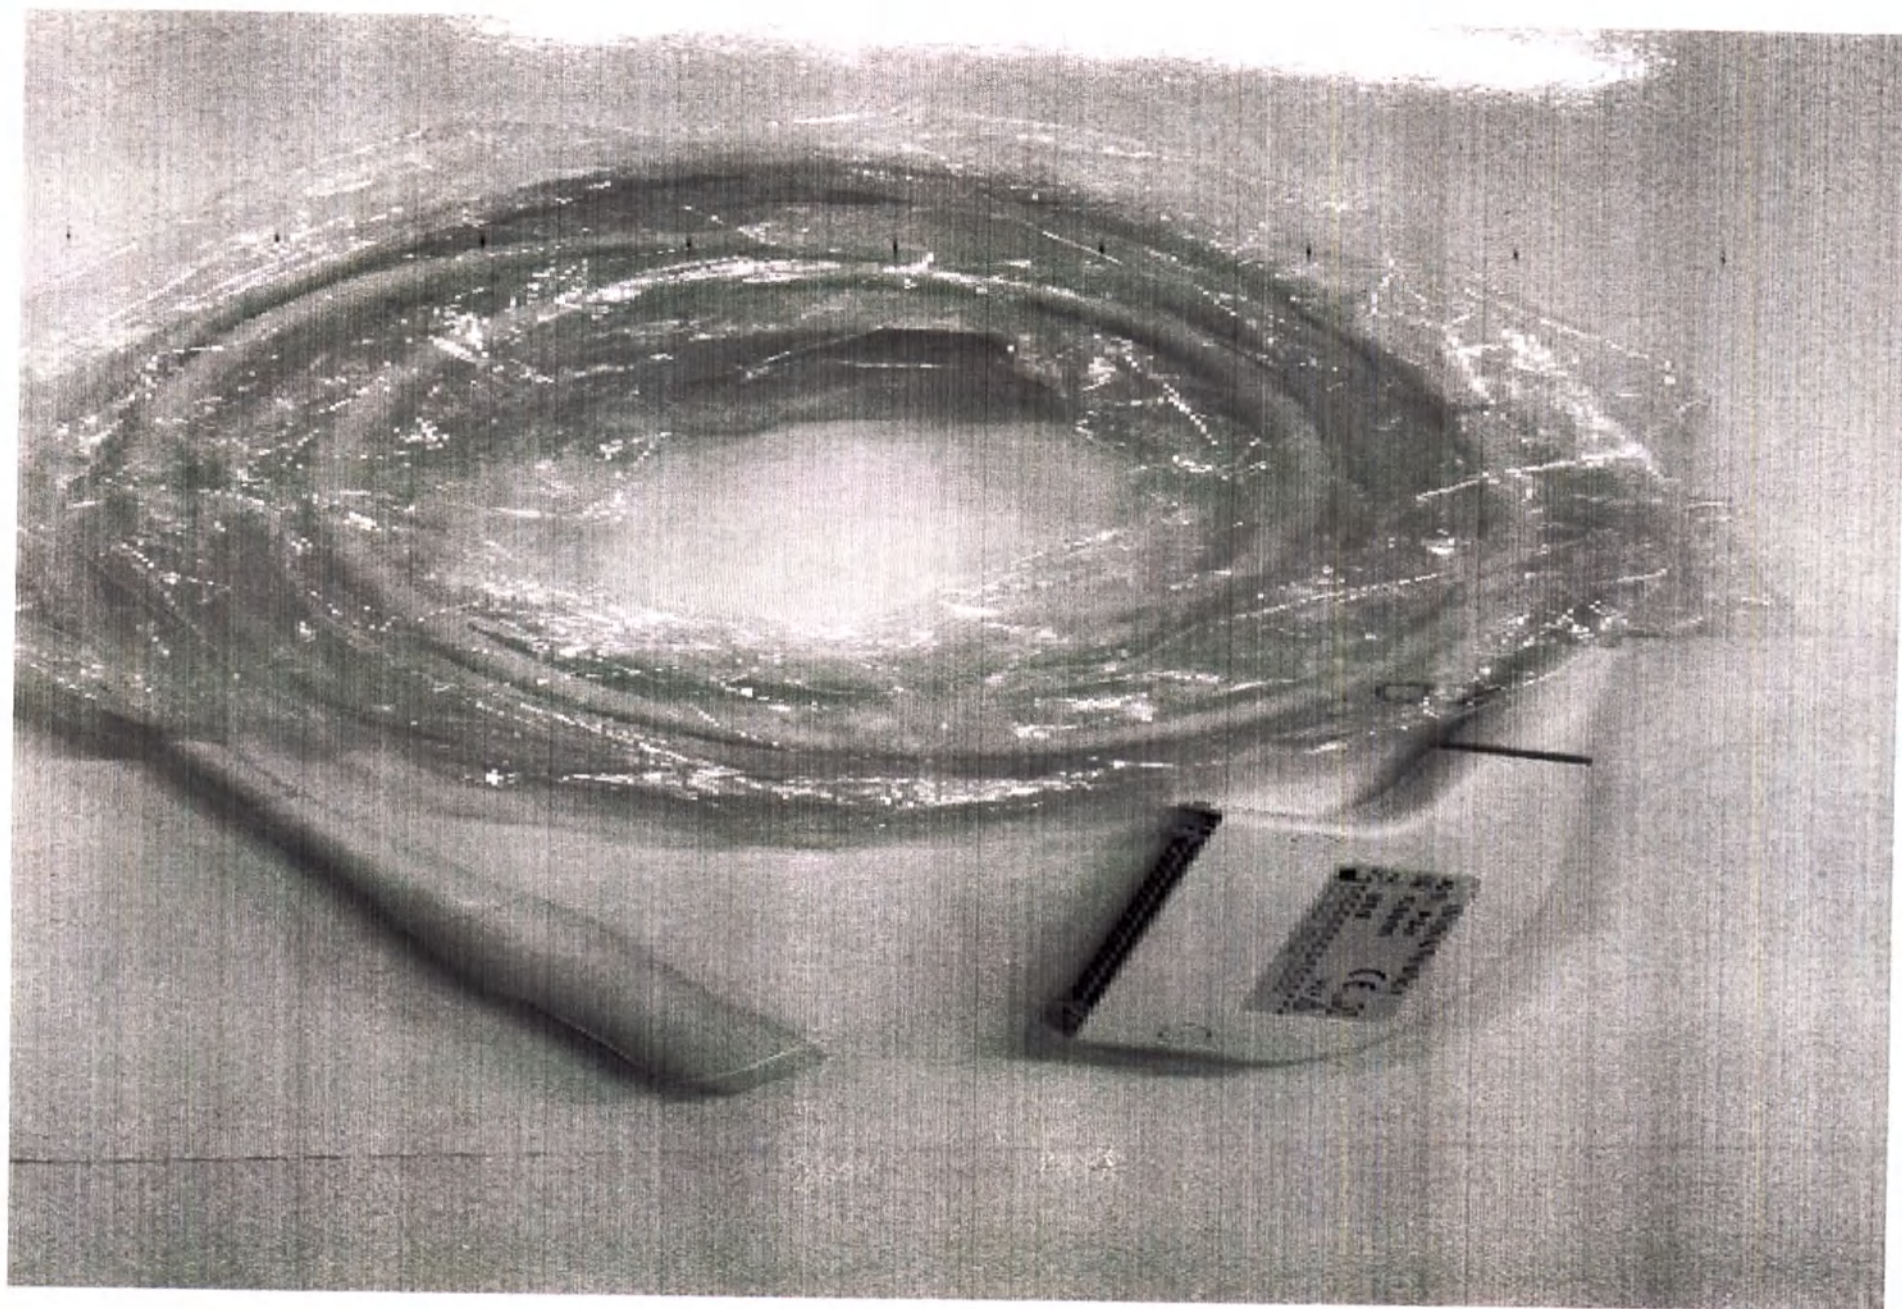


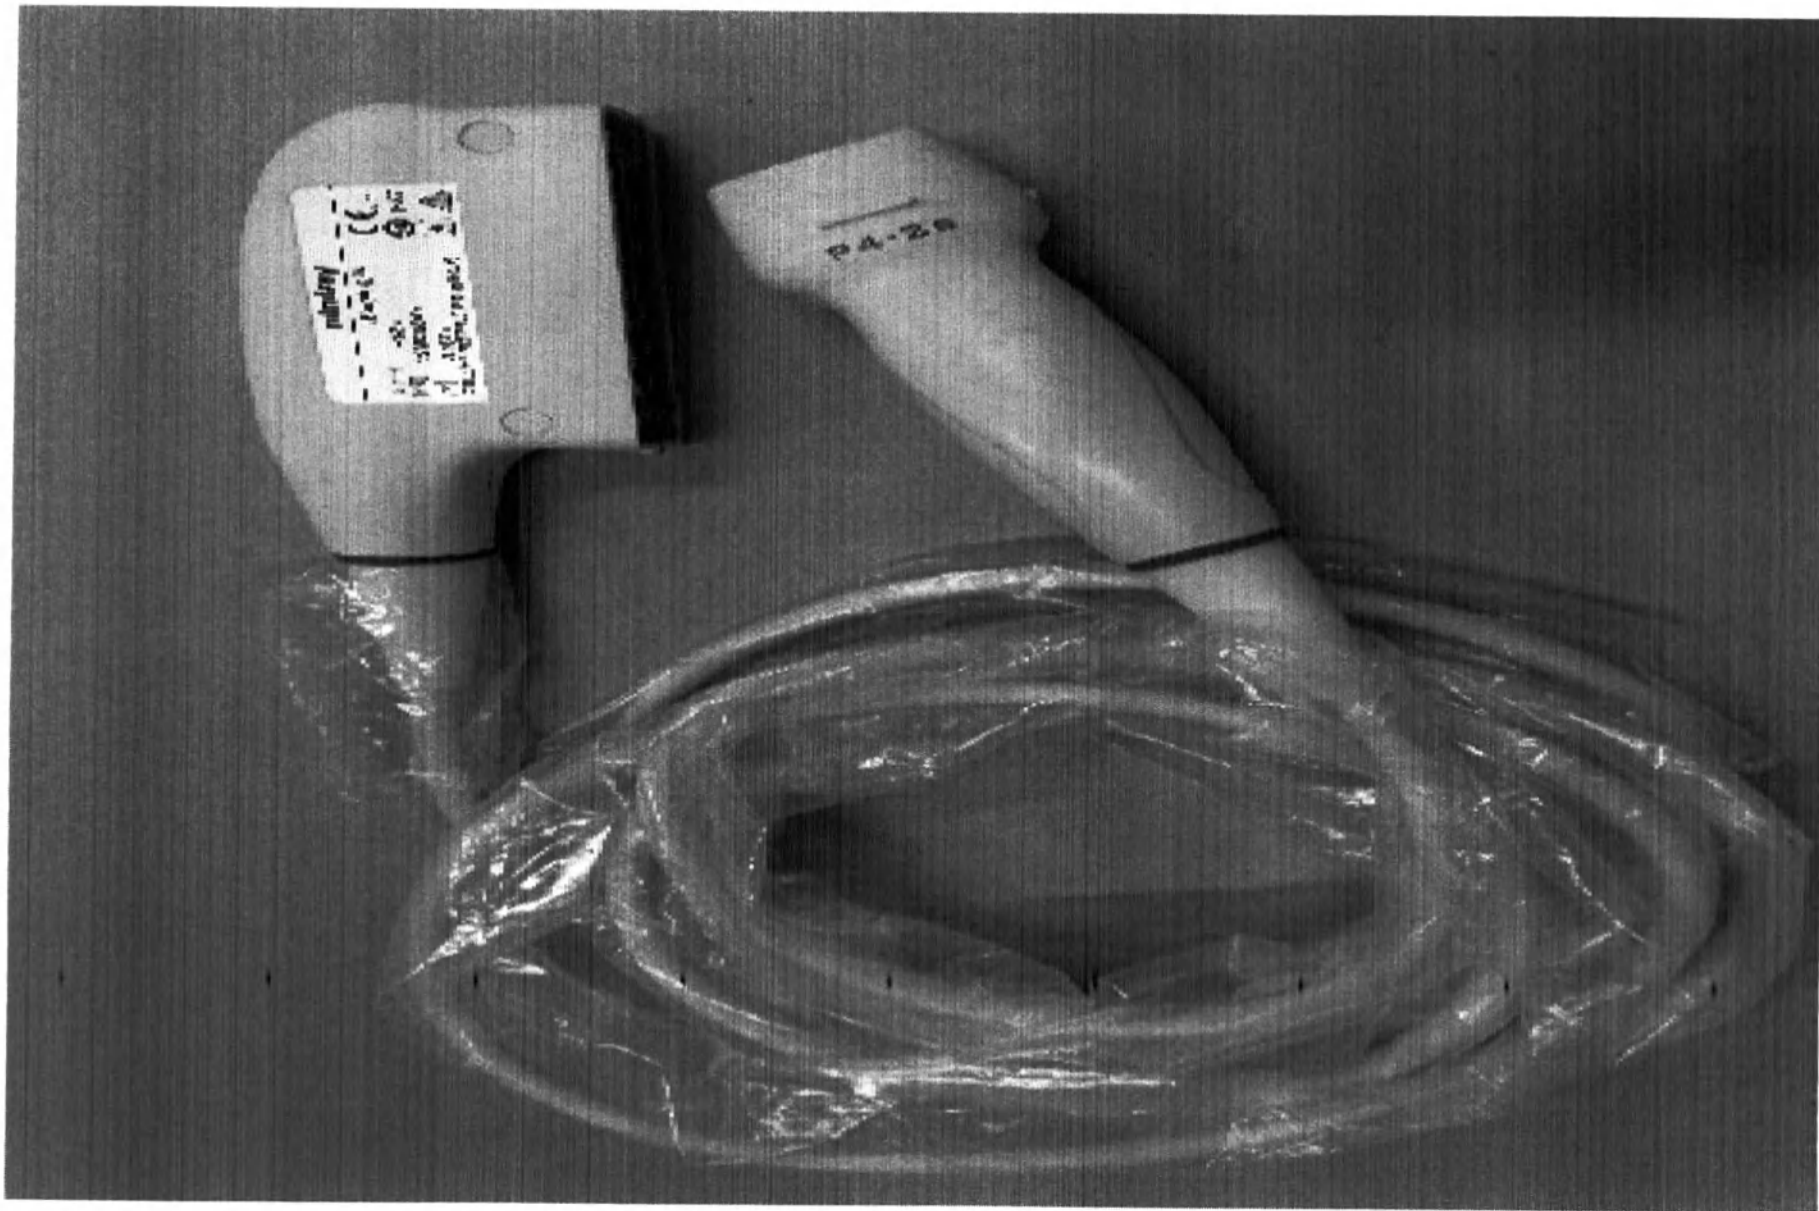

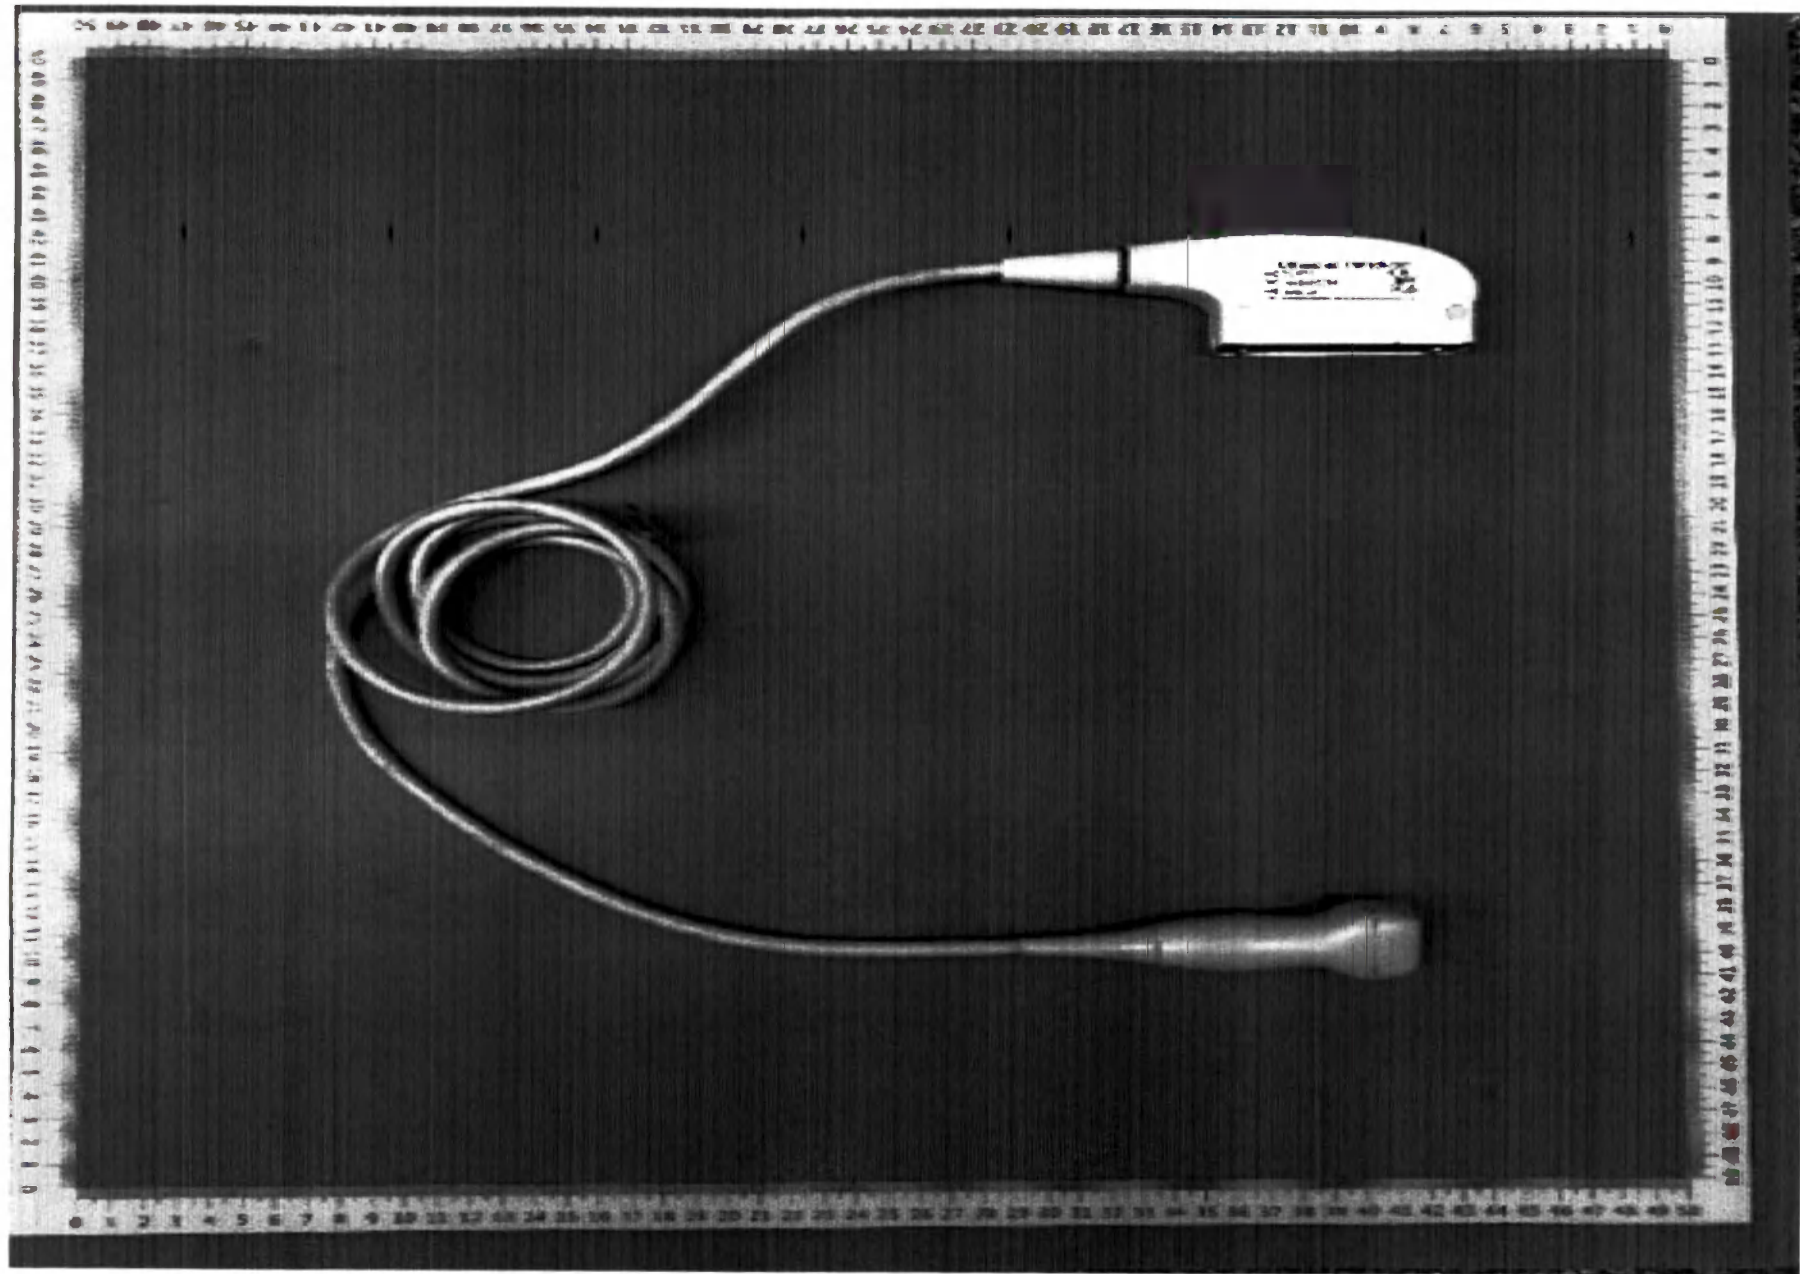



24.21. Датчик ультразвуковой фазированный чреспищеводный Р7-3Тs в составе:

24.21.1. Датчик ультразвуковой фазированный

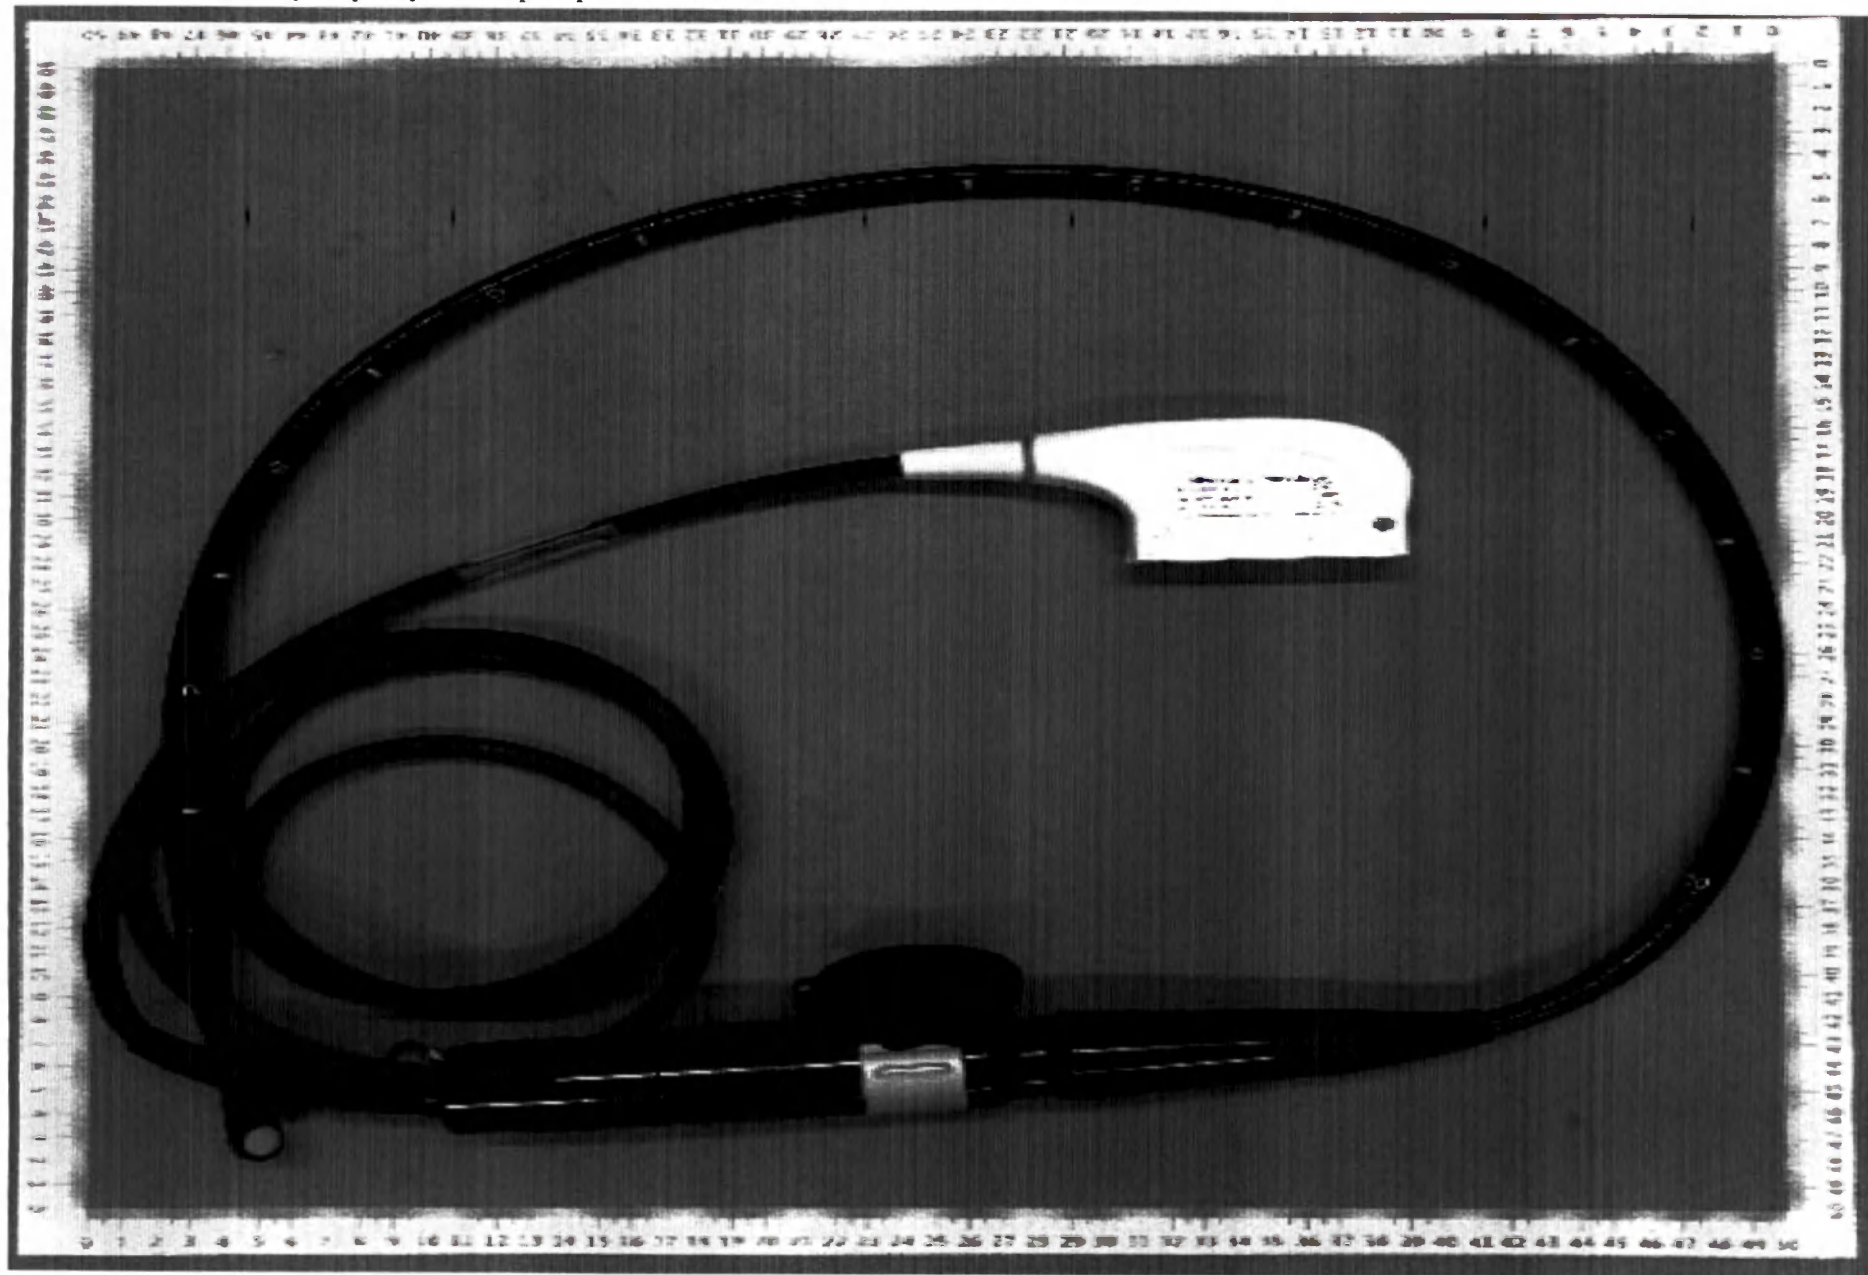




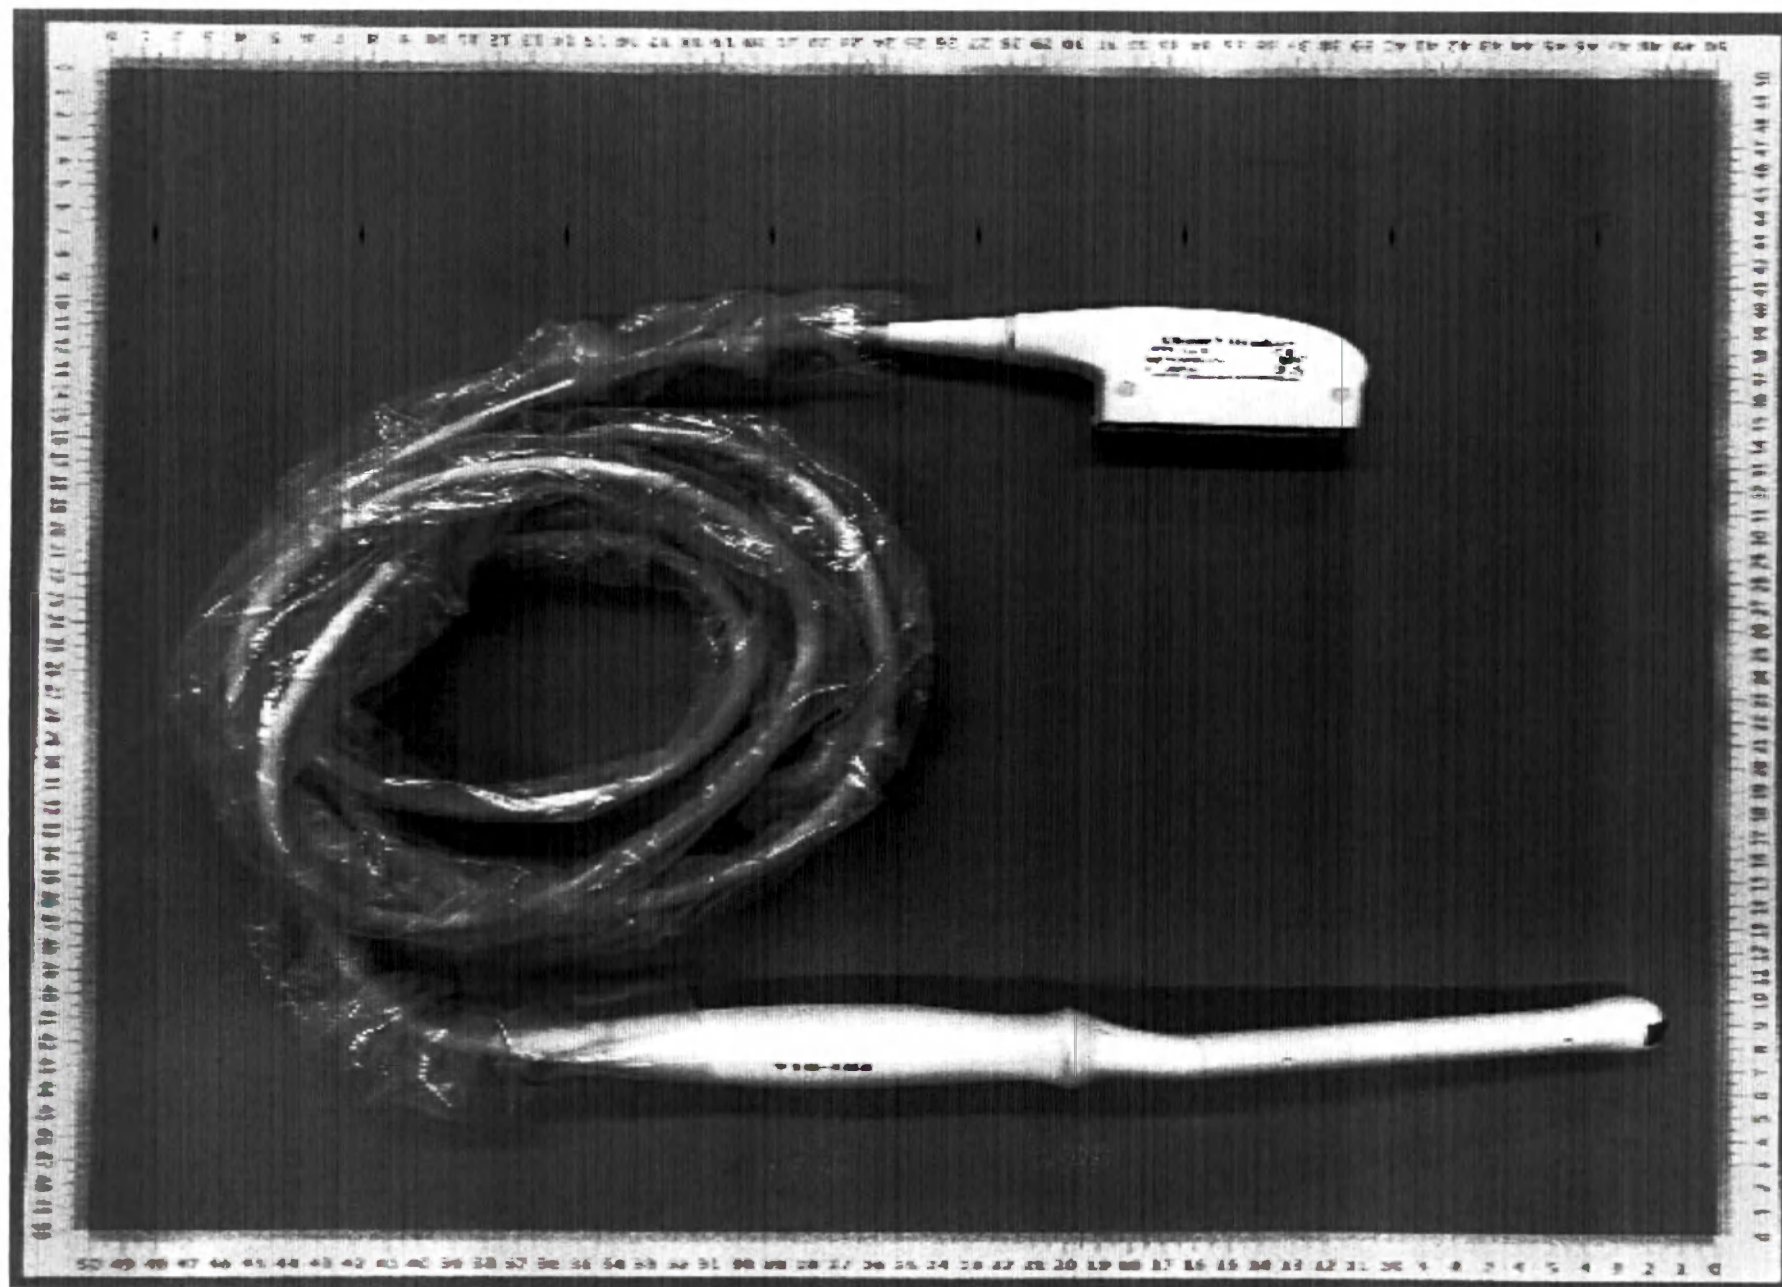


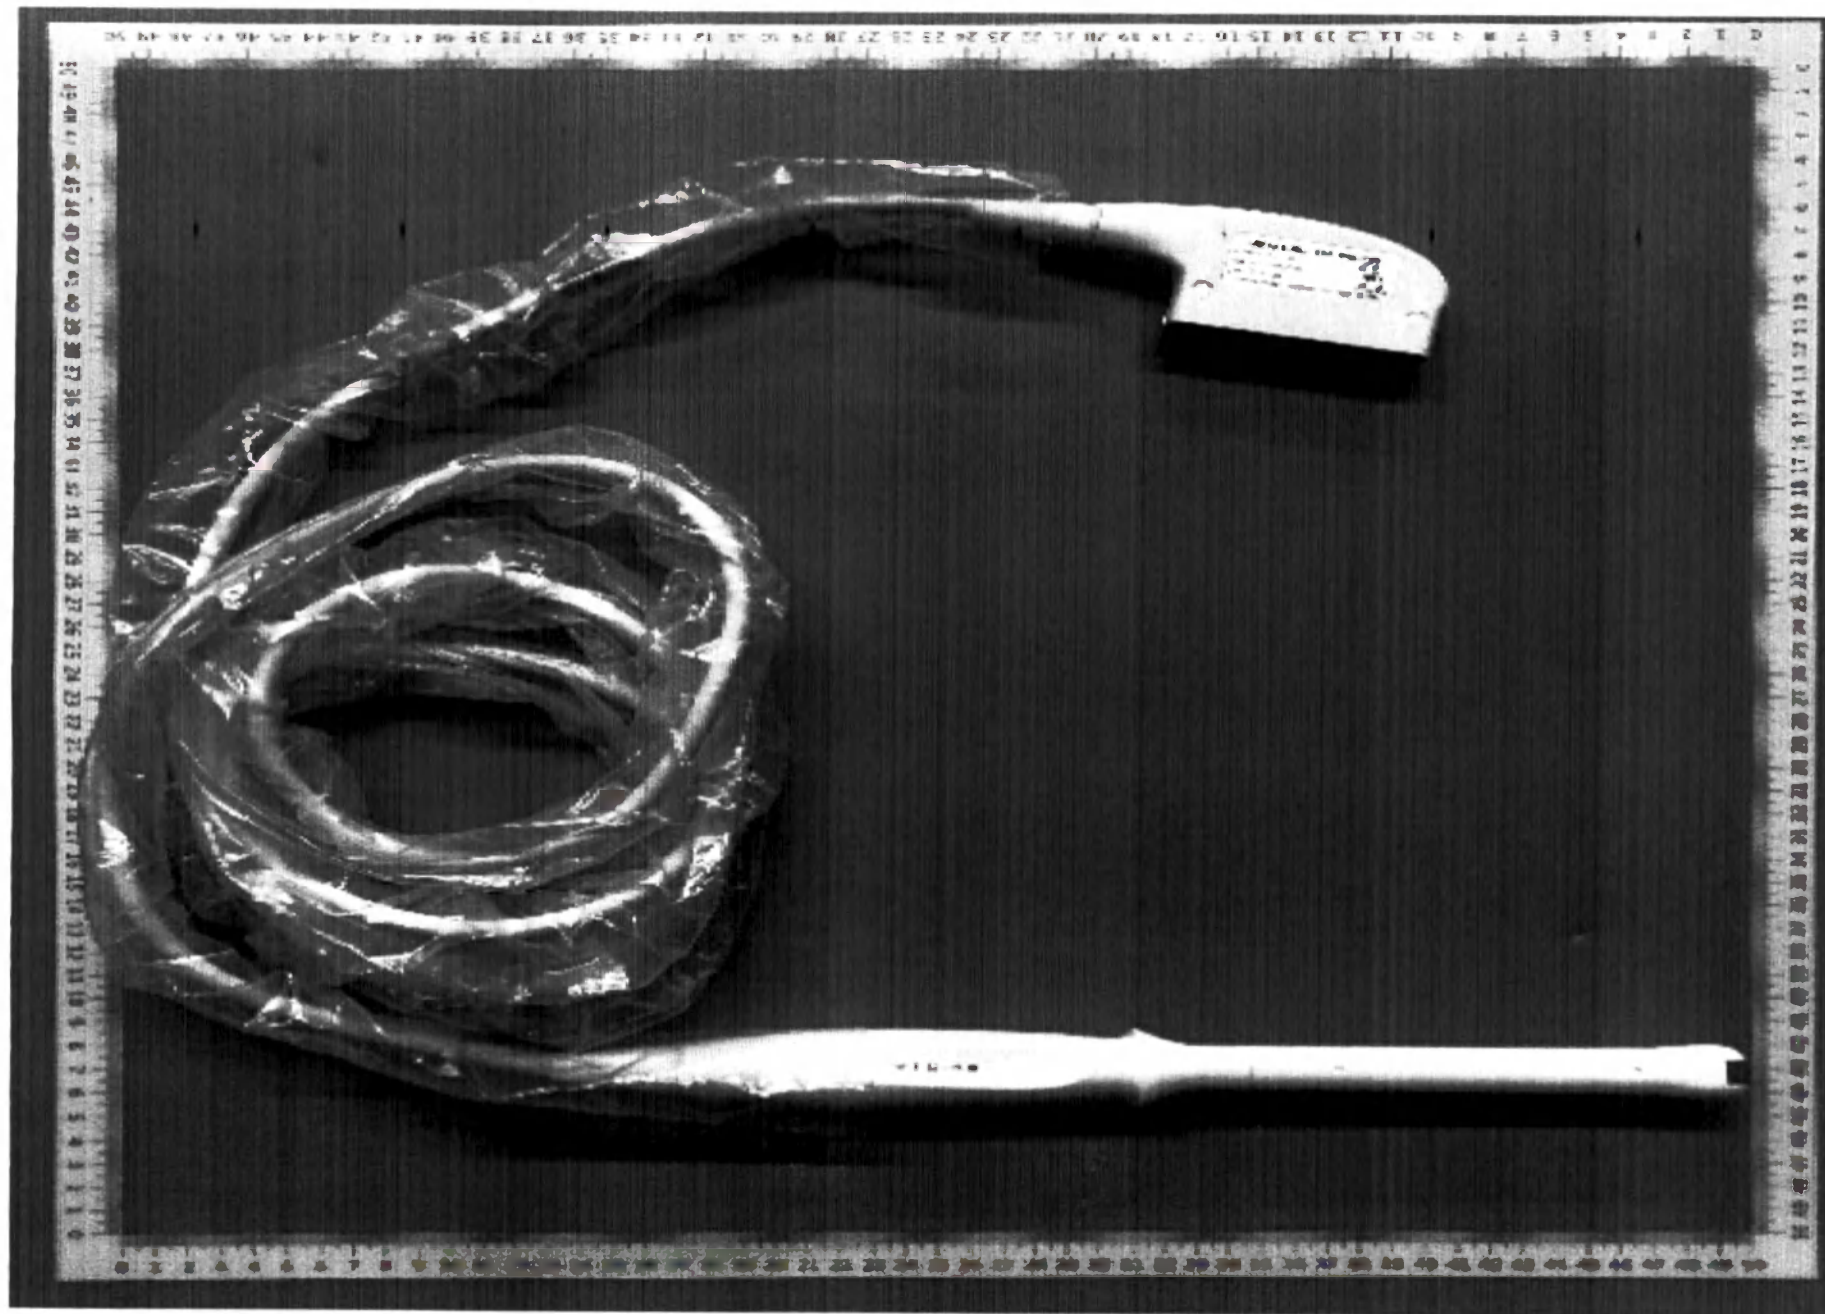


25. Насадки биопсийные, варианты исполнения


25.1. Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

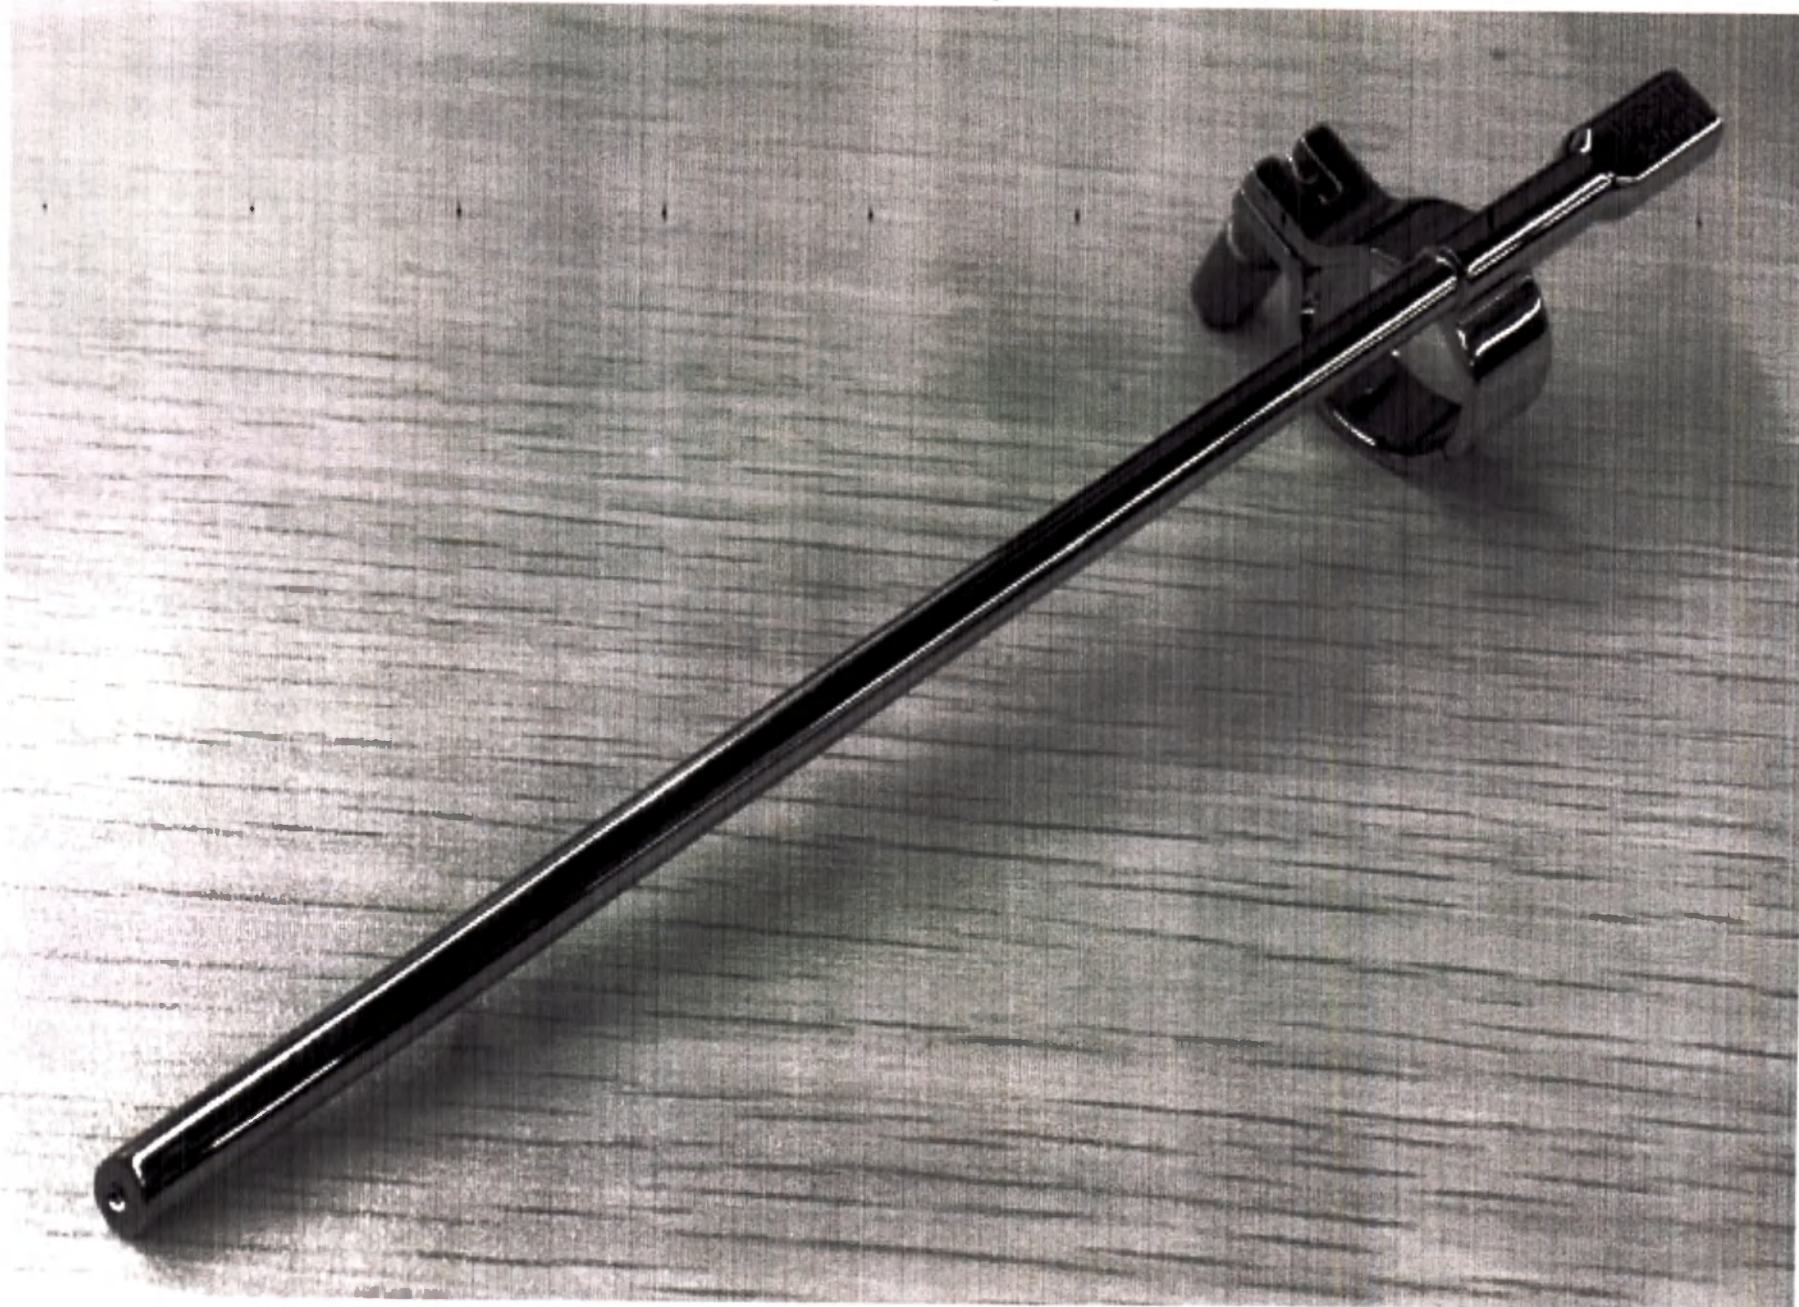


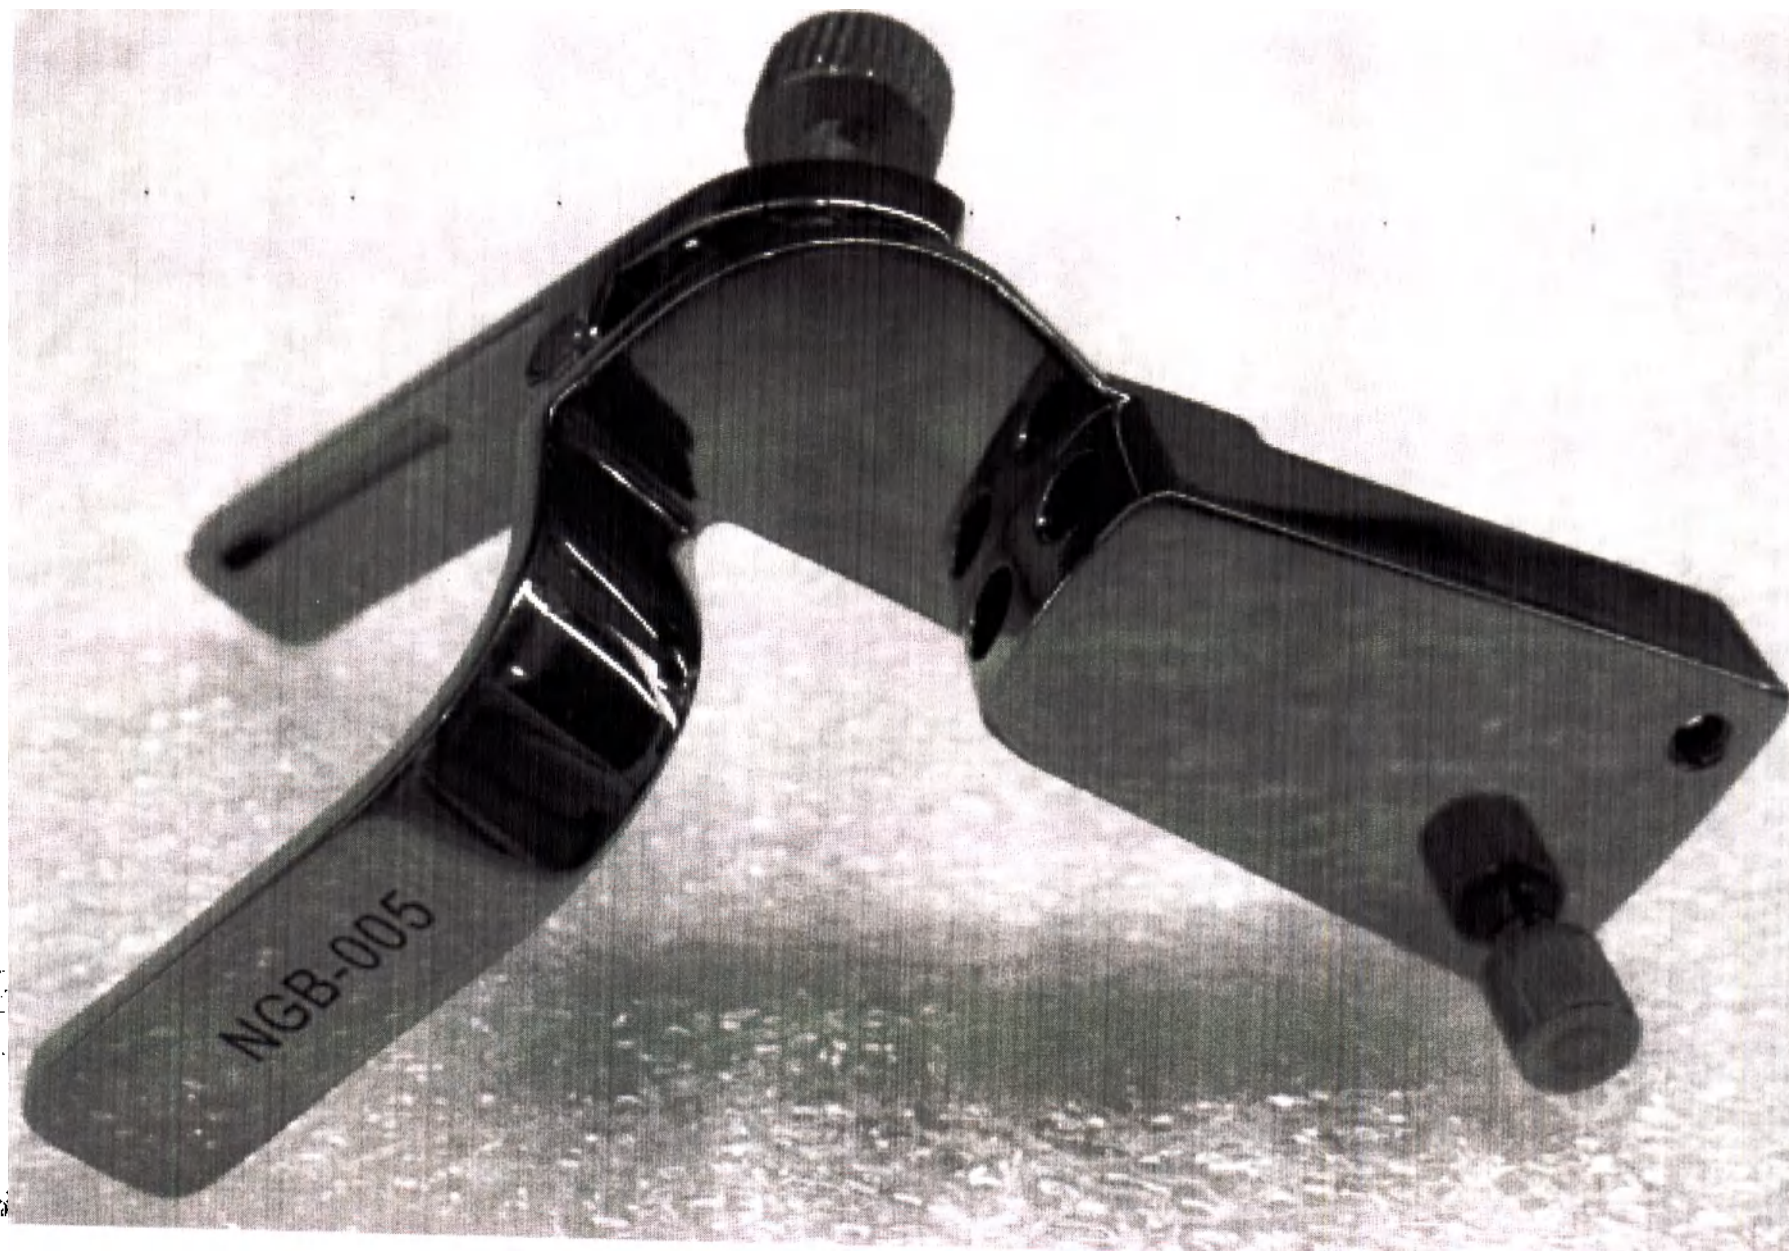





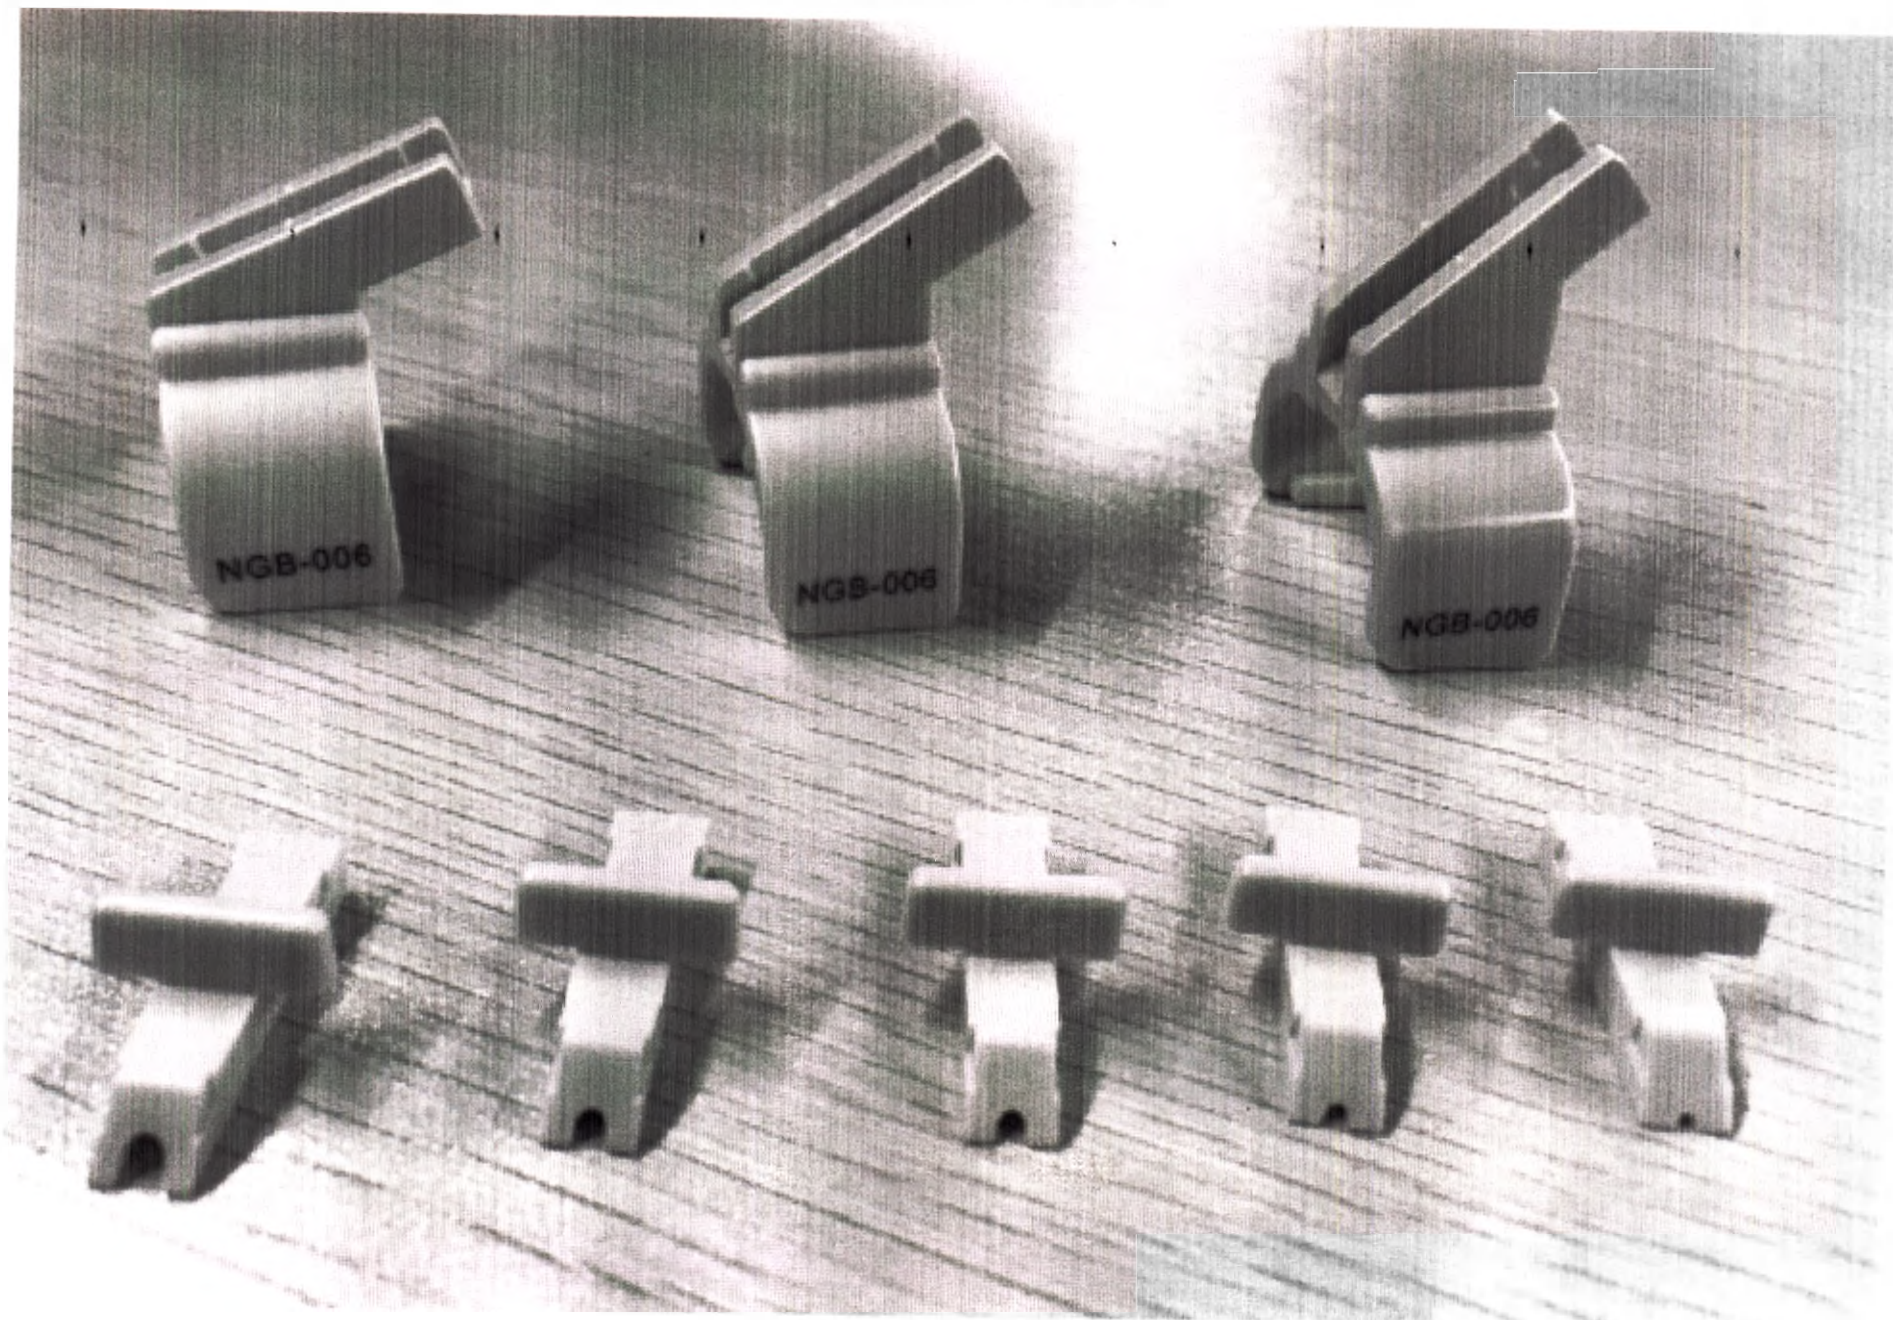


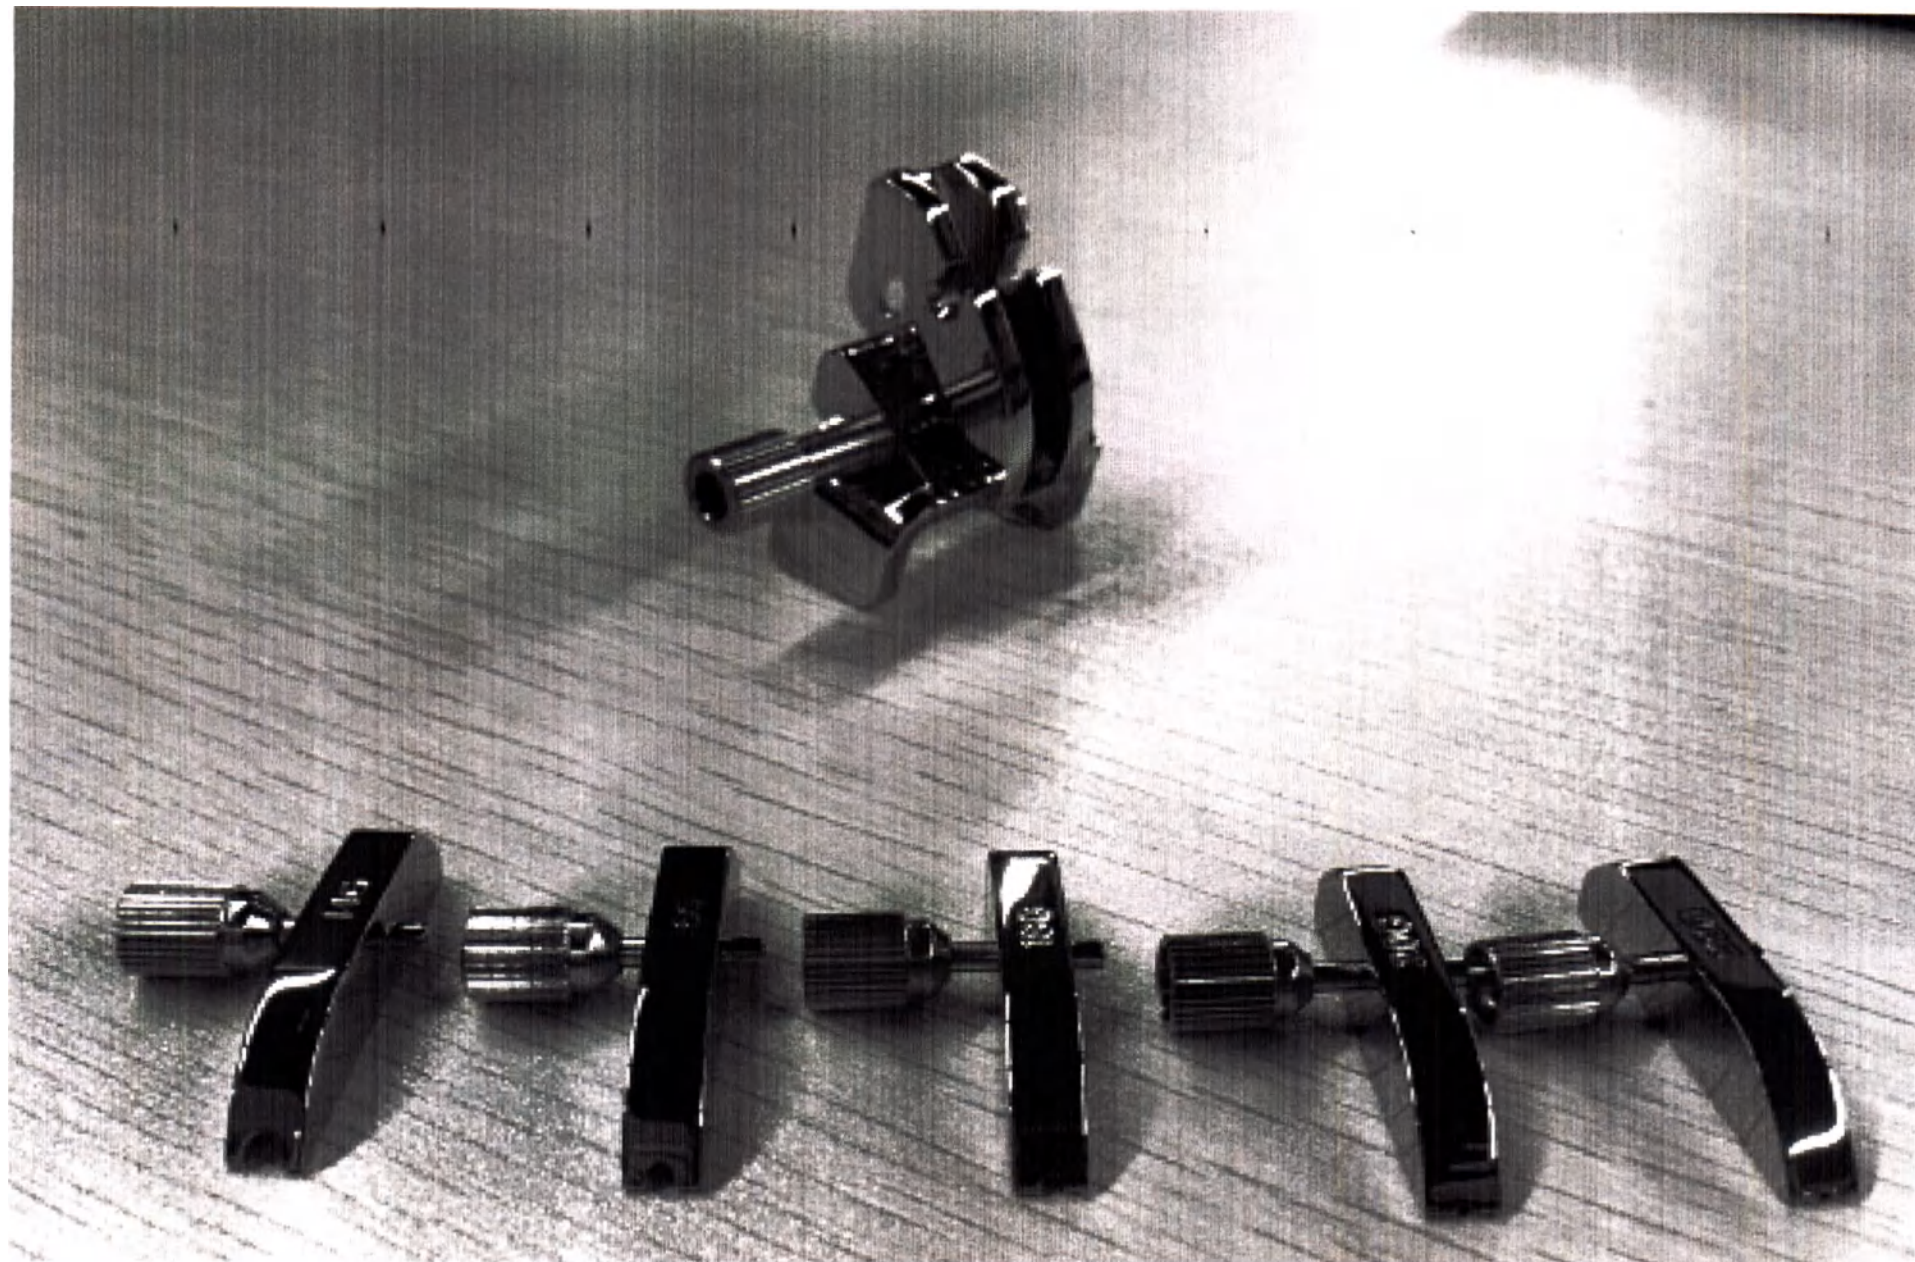

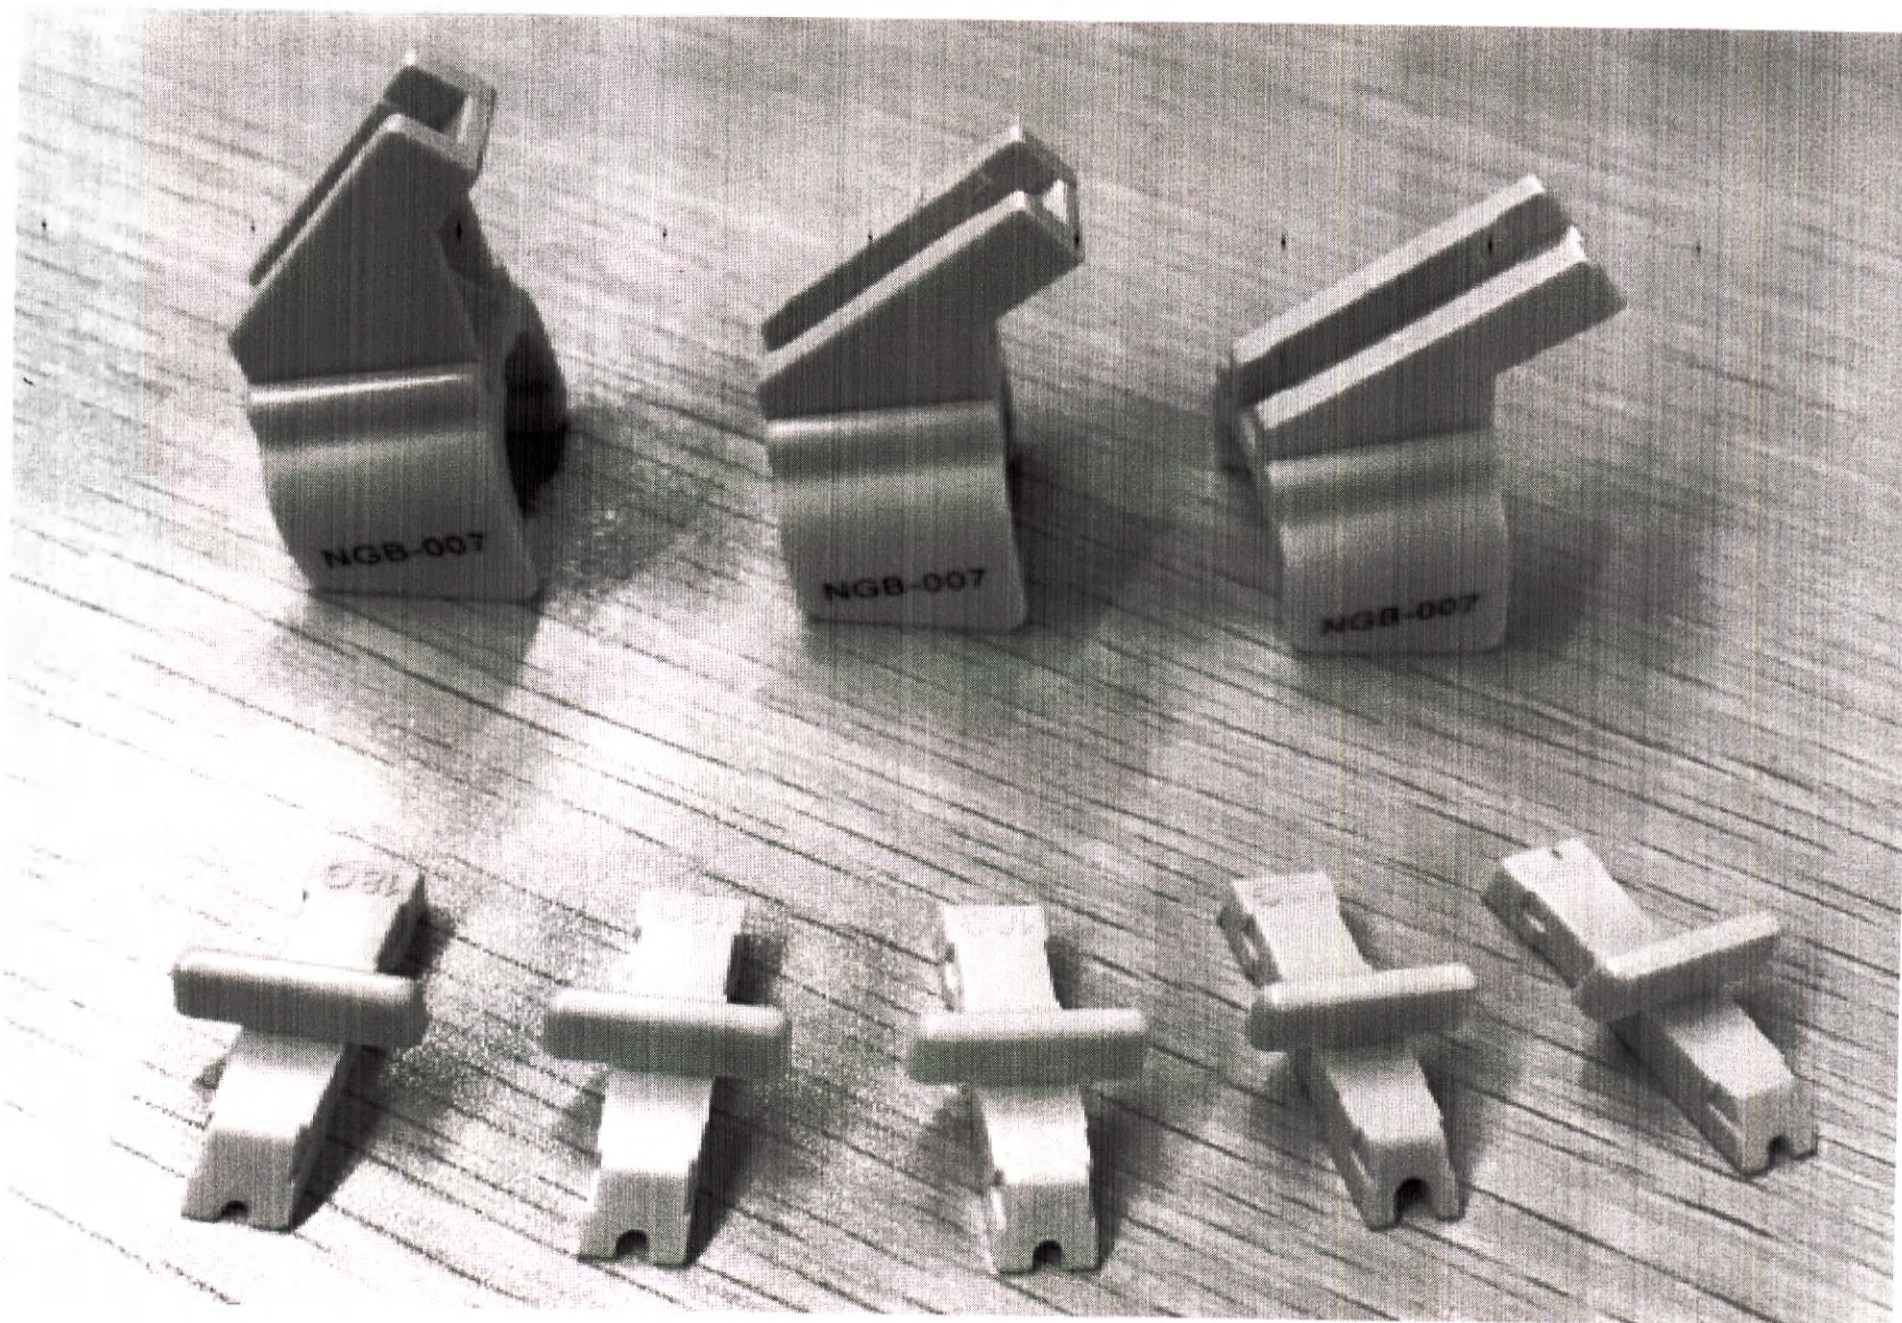

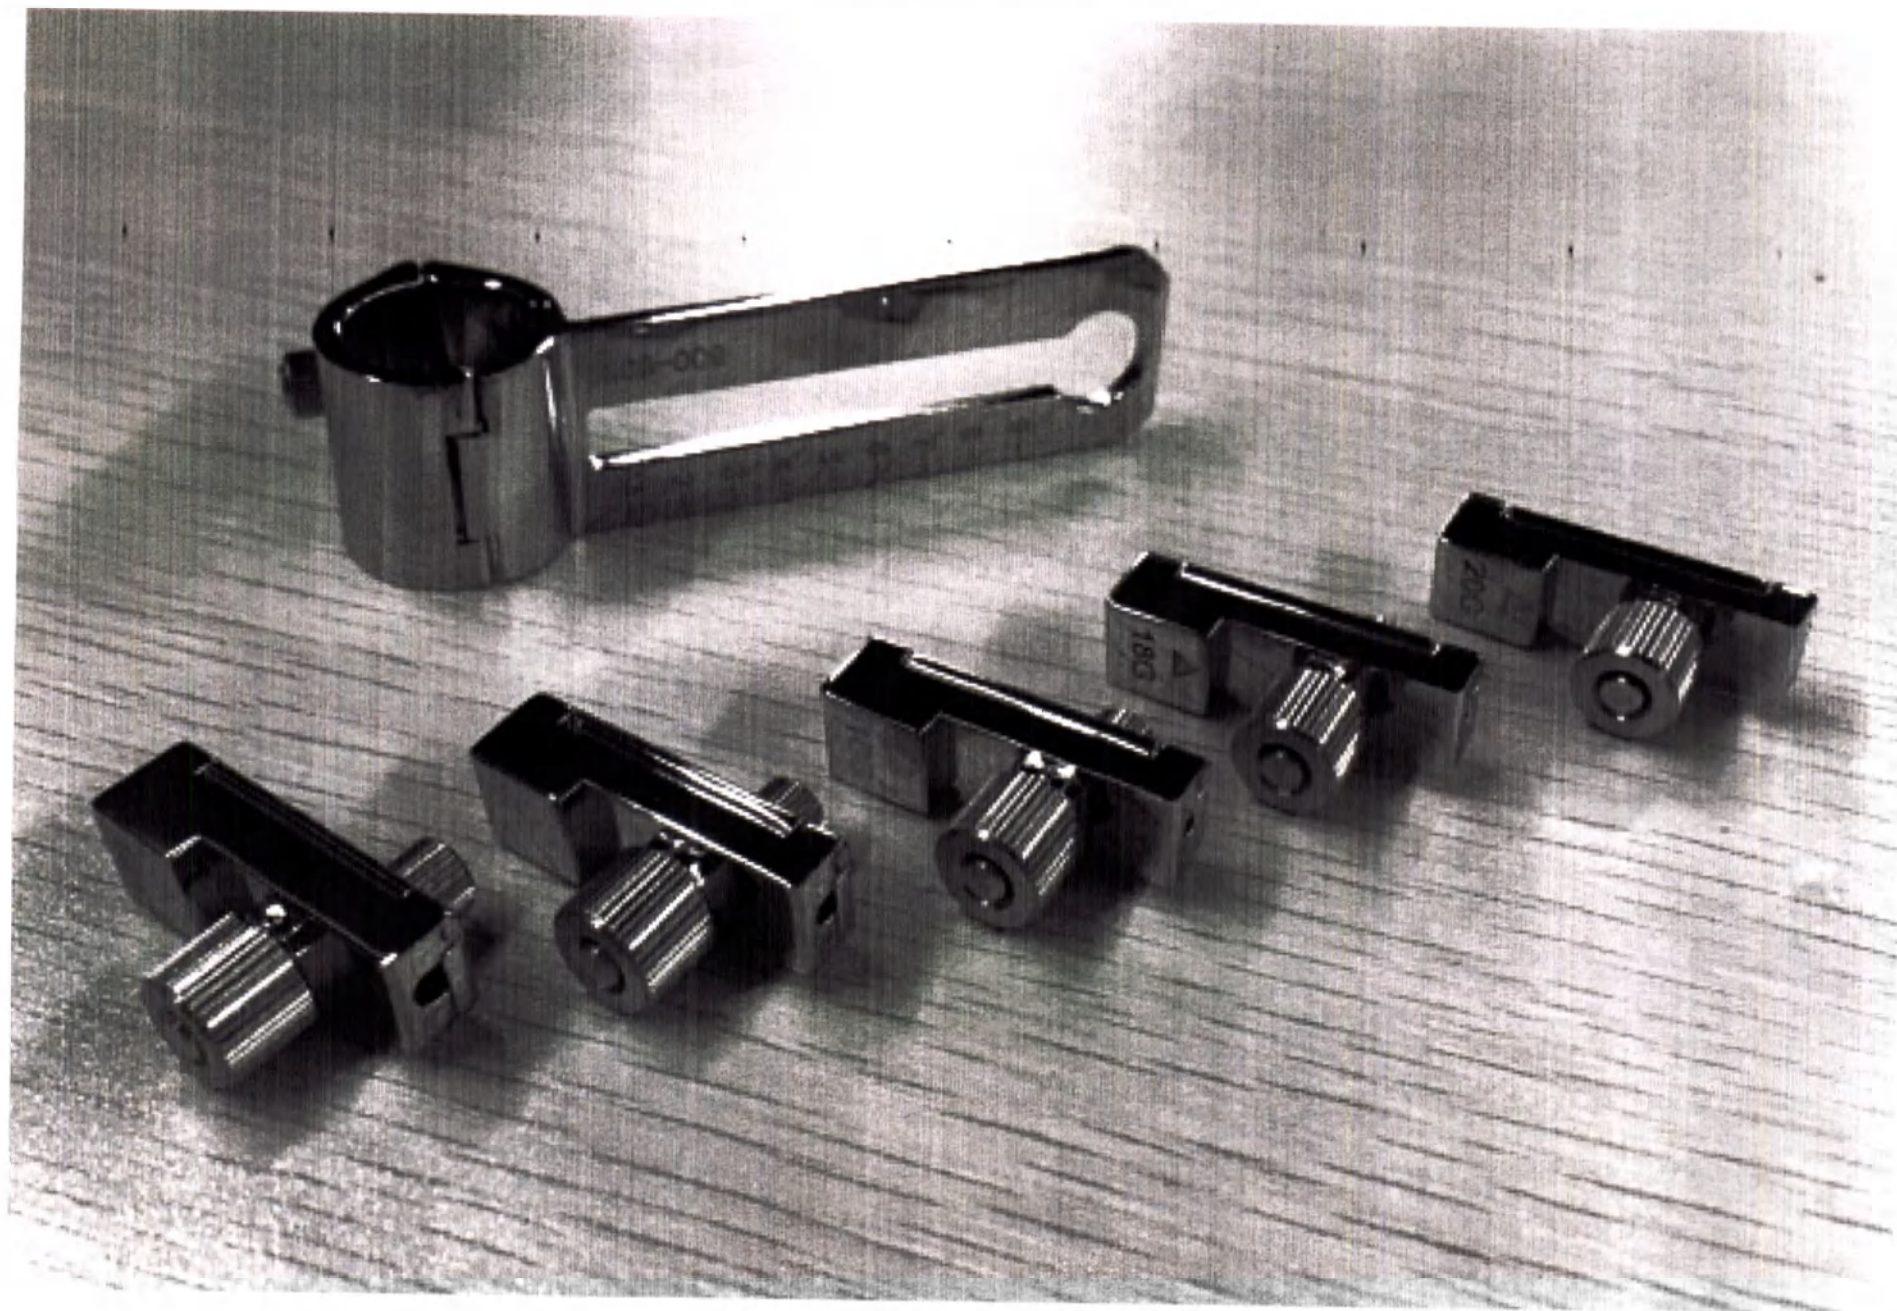

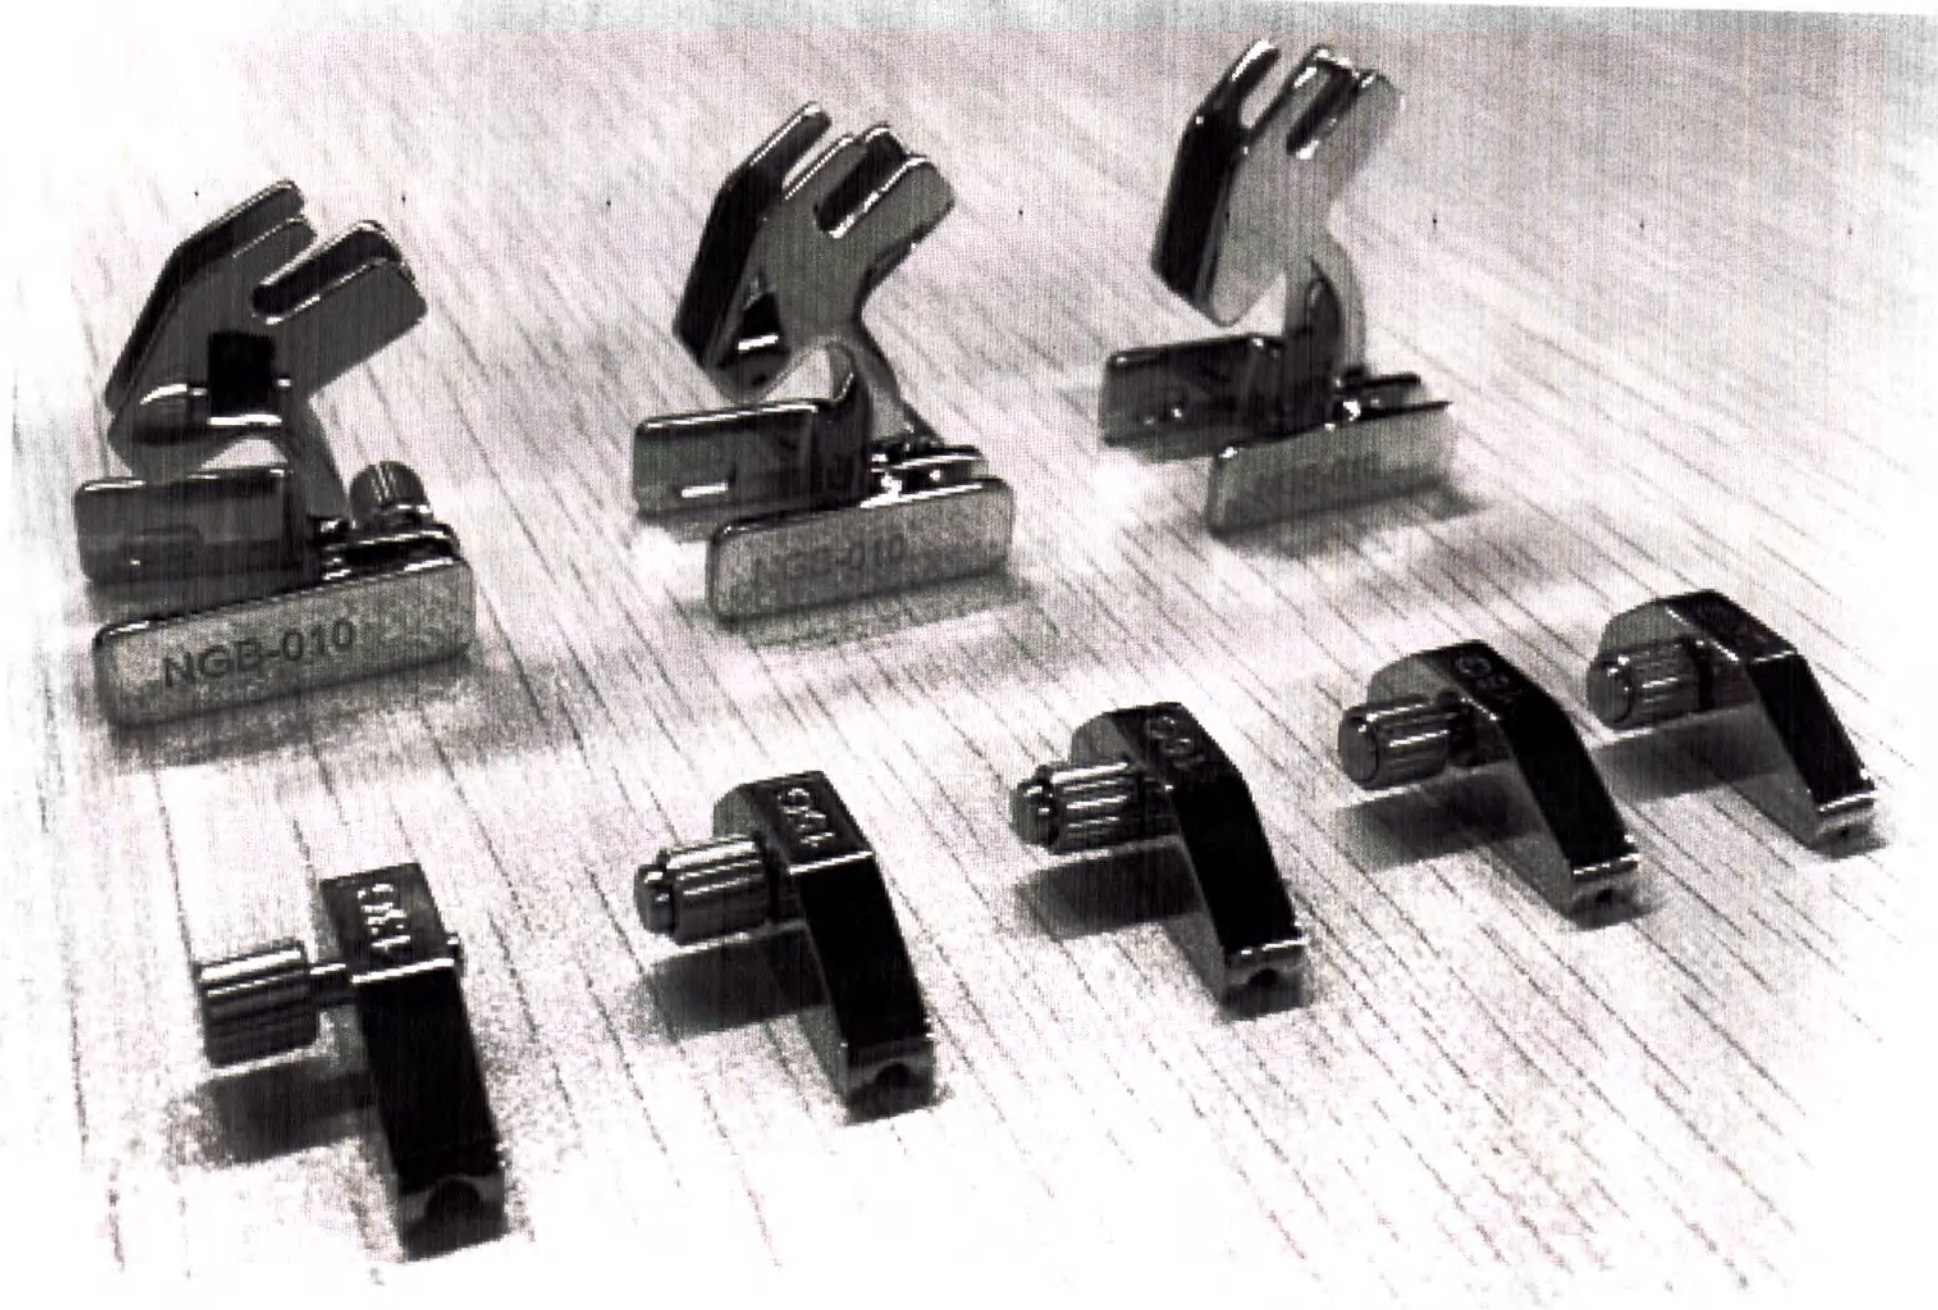

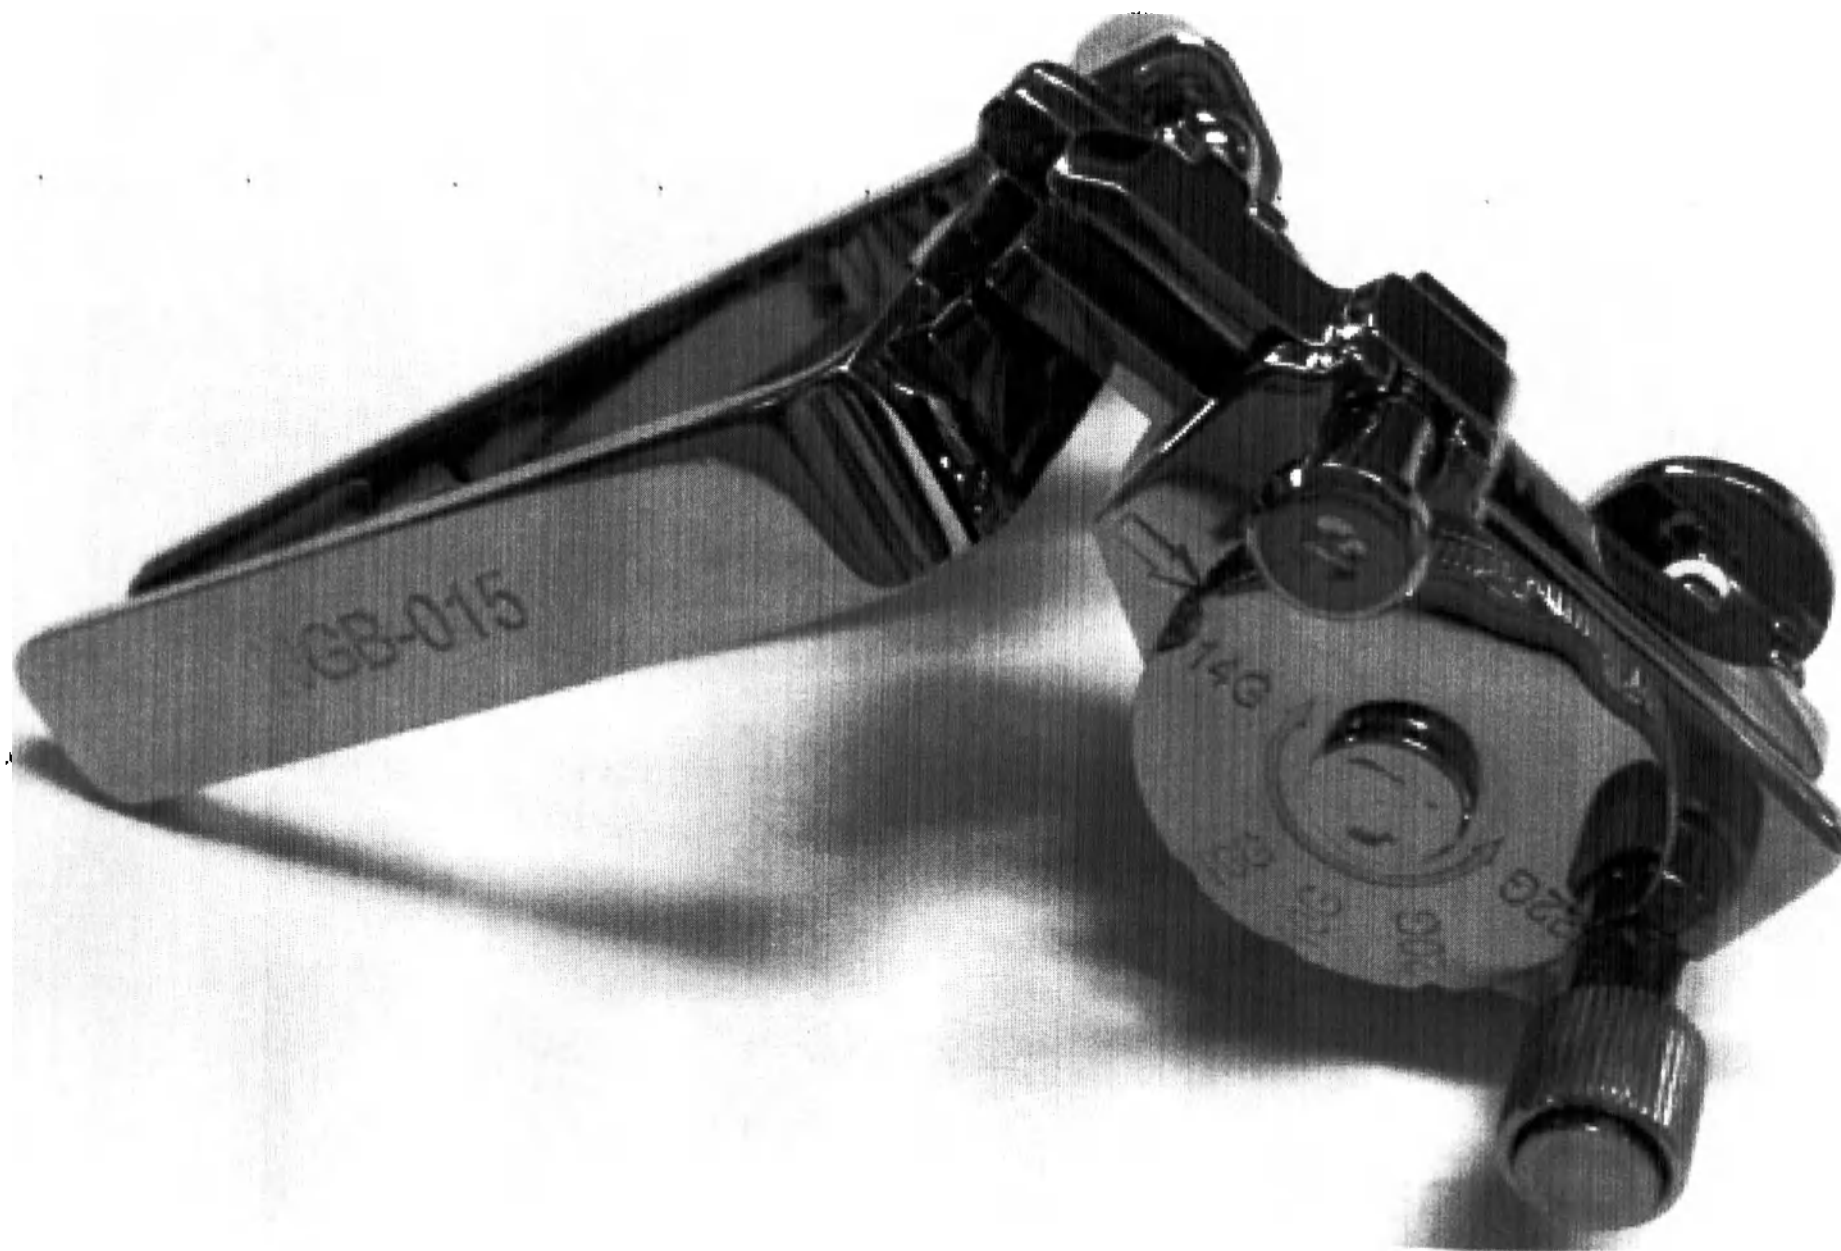




25.11. Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018




26. Программное обеспечение:

26.1. Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package)



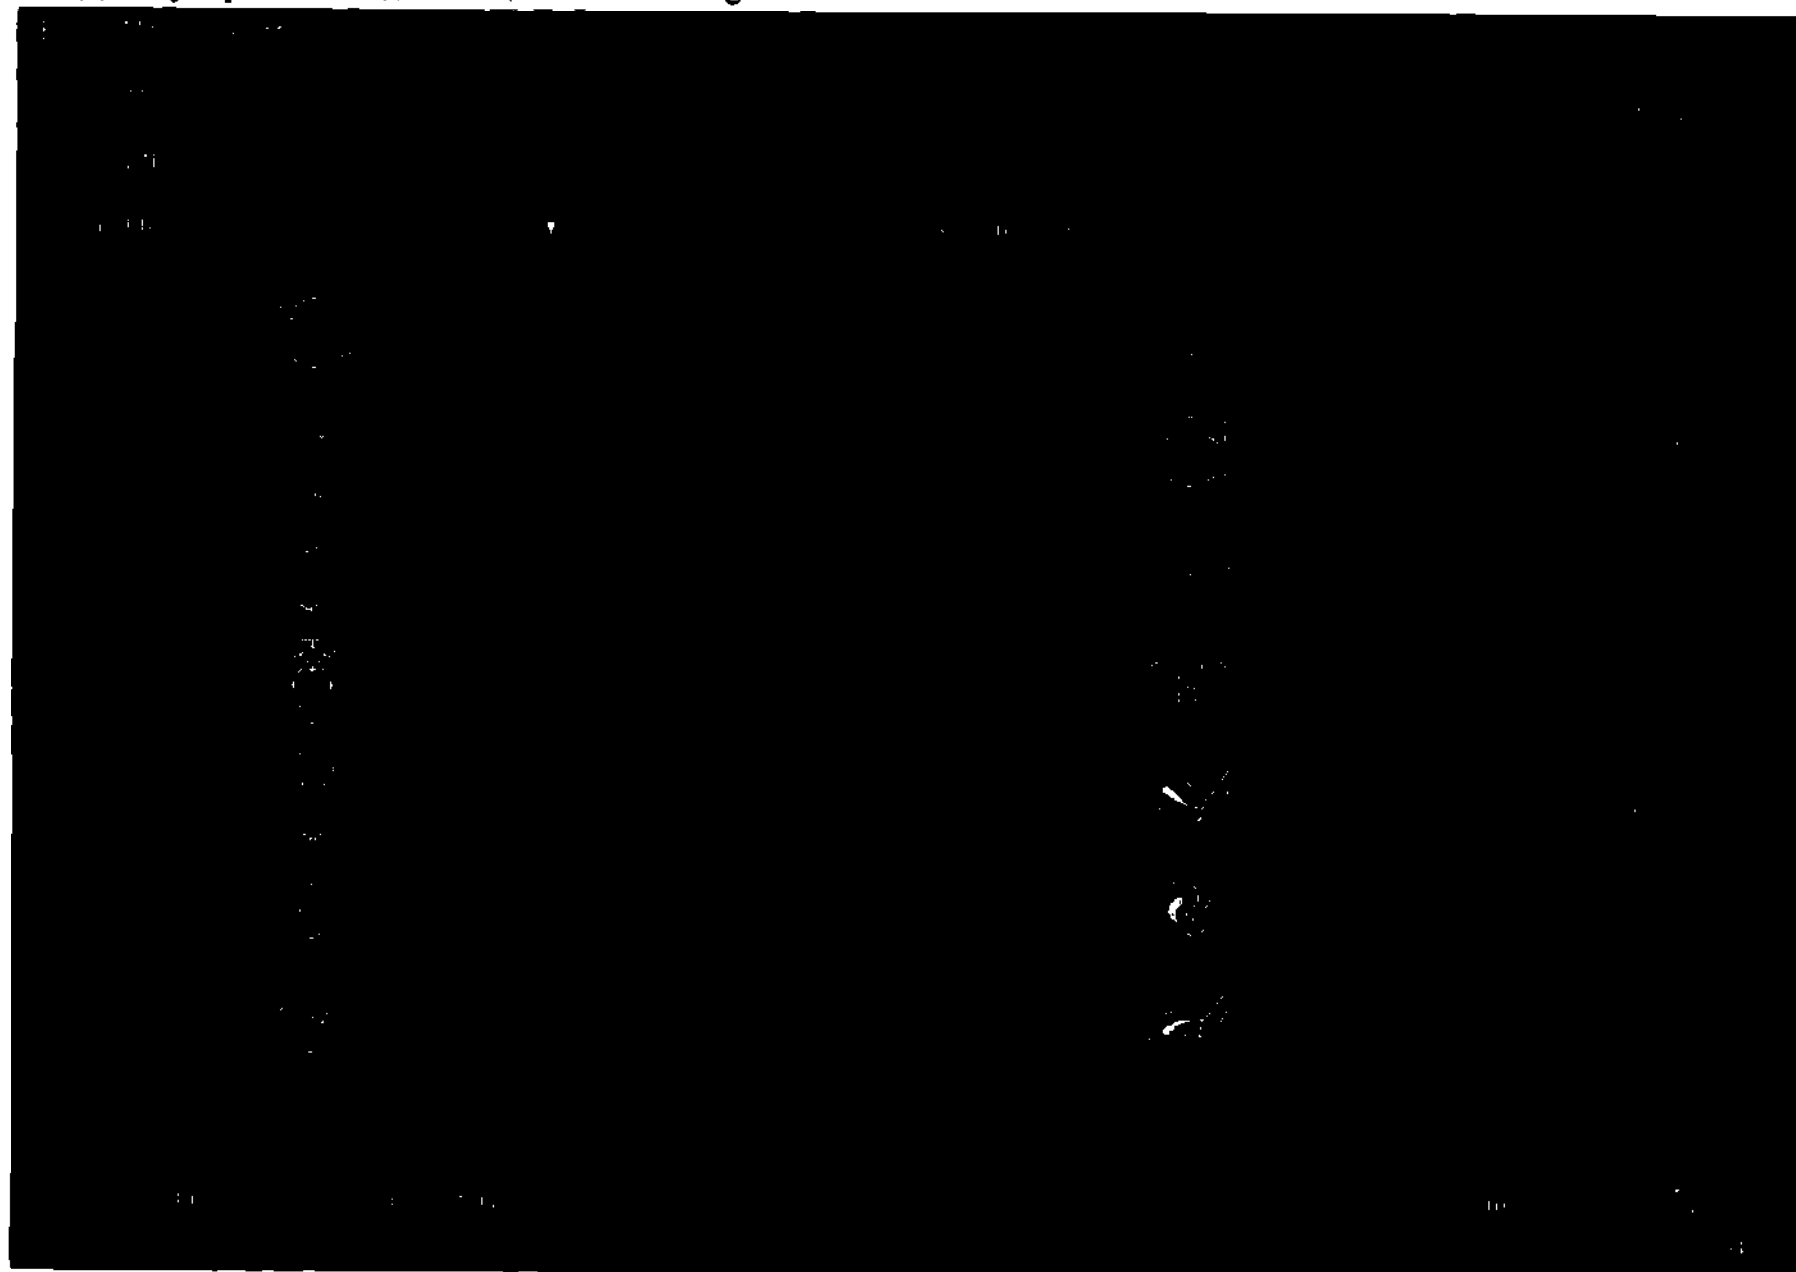




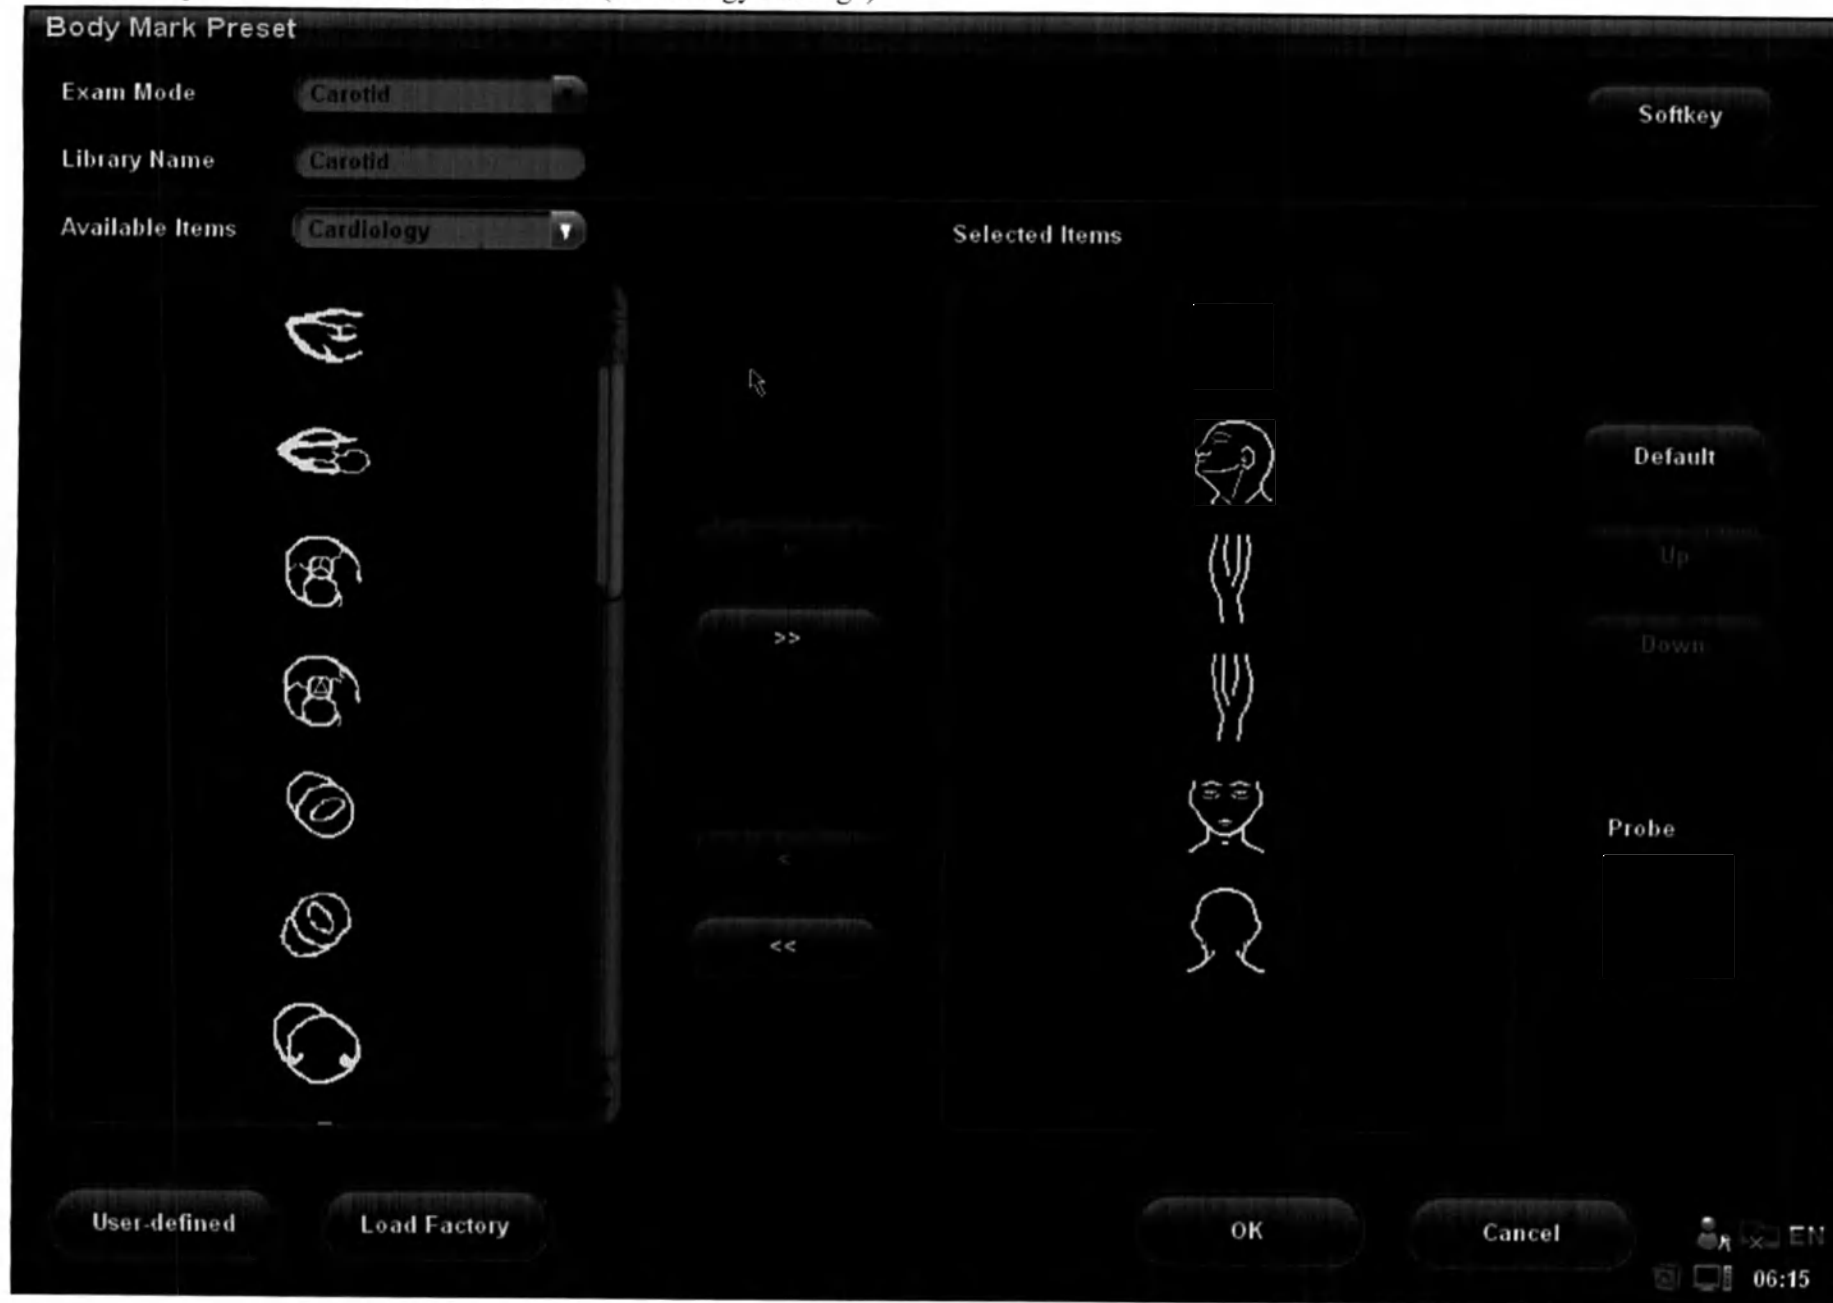



26.6. Для урологических исследований (Urology Package)

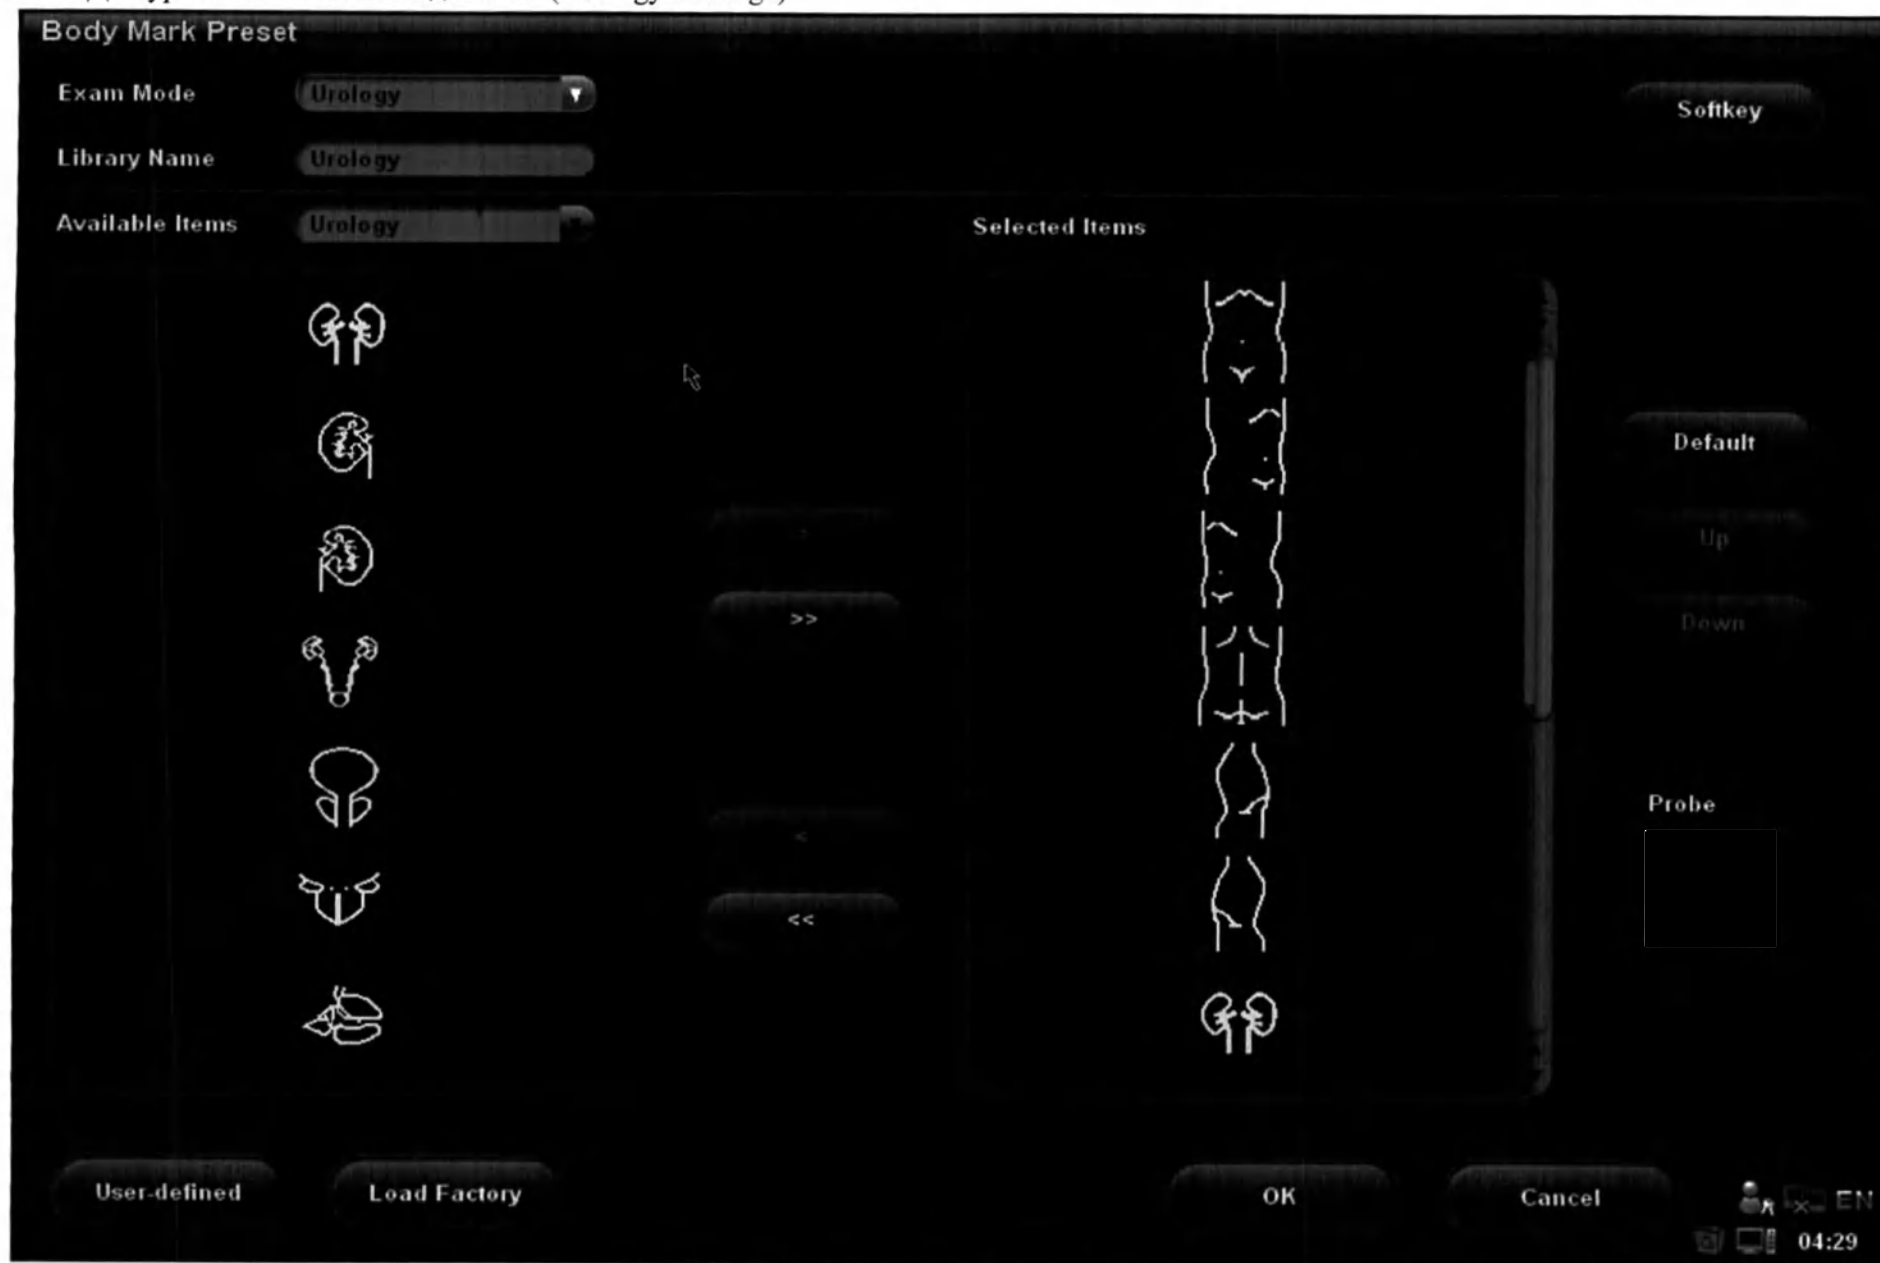

26.7. Для сосудистых исследований (Vascular Package)






612





20.11. Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, кардиологических, исследований малых органов, урологических, сосудистых, исследований нервов, исследований при неотложных состояниях и в педиатрии) (Shared service package)







Body Mark Preset

Exam Mode: **Cardioid**

Library Name: **Cardioid**

Available Items: **Cardiology**

Softkey

Selected Items



Default

Up

Down

Probe

User defined


Load Factory


OK

Cancel

00:15



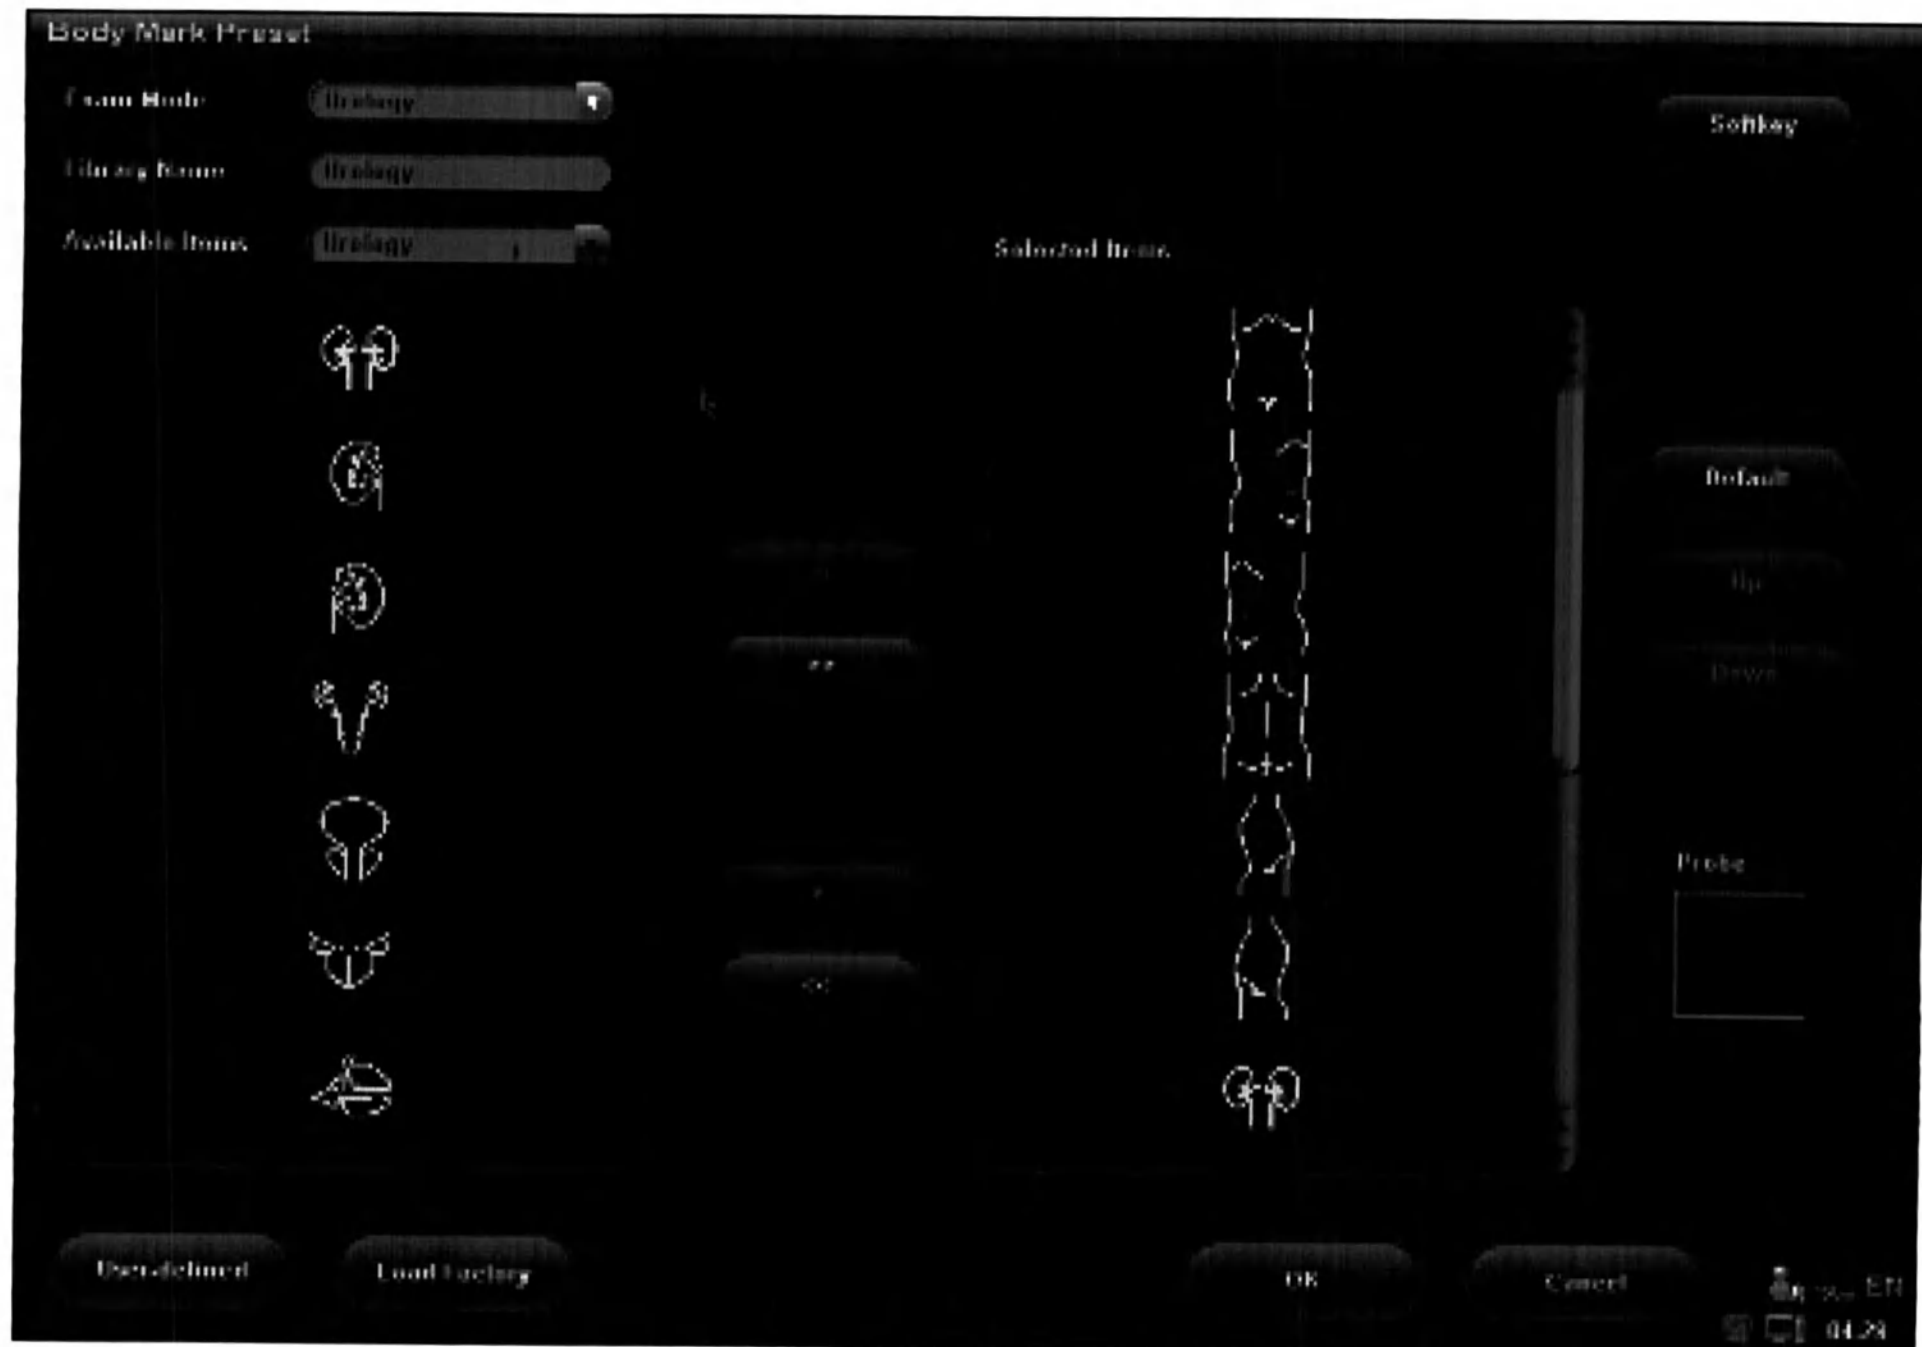

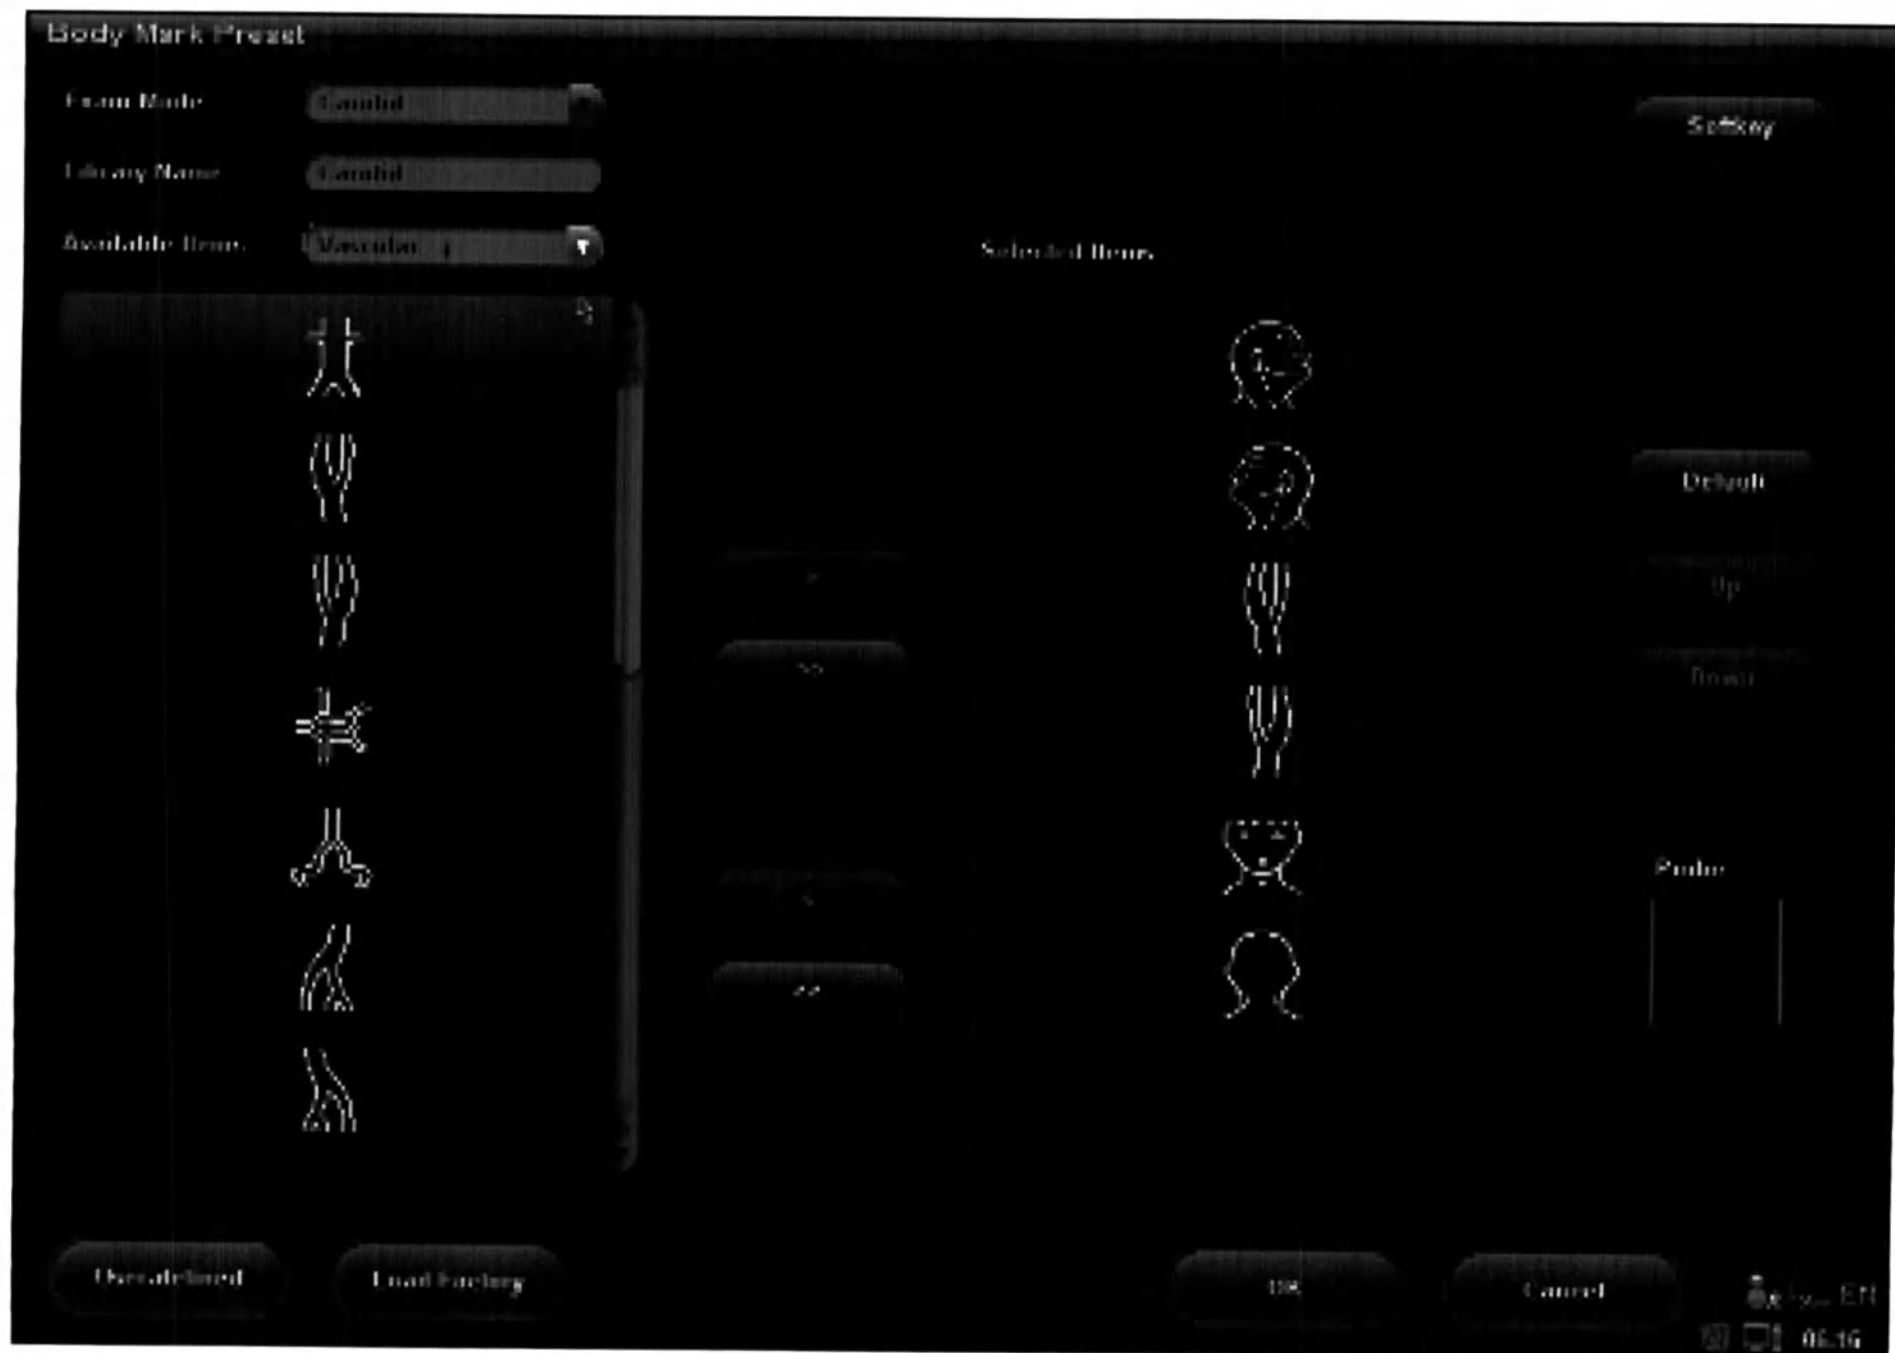

10

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

1 2 3

Exam Mode

Library Name

Available Items

General Nerve

General Nerve

Nerve



User defined

Load Factory

OK

Cancel



Selected Items

Library

Default

Up

Load Factory

Printer

01:21



26.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCominitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12.Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option
Not Store SR

Add
Cancel
Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12.Storage		104	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
06:09

26.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
Storage Commitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Worklist
AE Title
Port
104
Maximum Retries
1
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Scheduled Station AE Title

Add
Cancel
Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-Worklist		104	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
03:36

26.14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device12

Service Name12-MPPS

AE Title

Port104

Maximum Retries3

Interval Time(Sec)15

Timeout(Sec)15

Add
Cancel
Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-MPPS		104	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit

EN
03:37

DICOM Service

Storage

Print

Worklist

MPPS

StorageCommitment

Query/Retrieve

Configure the New Service

Device

12

Service Name

12-QueryRetrieve

AE Title

Port

104

Maximum Retries

1

Interval Time(Sec)

15

Timeout(Sec)

15

Add

Cancel

Update

Service List

	Device	Service Name	AE Title	Port	Default
1	12	12-QueryRetrieve		104	N

Delete

Default

Verify

Verification is required!

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device: Service Name: AE Title: Port:
 Maximum Retries: Interval Time(Sec): Timeout(Sec):

Cine Zoom Mode: Compression Mode: Compression Ratio:
 Color Mode: ☒ Allow Multiframe Max Framerate:

SR Storage Option:

Add
Cancel

Attach SR When Store Images
 Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
 Only Store SR
 Only Store SR and It Contains User-defined Measurements

Service List		Device	Default
1	12	Not Store SR 12-Storage	N

Delete
Default
Verify
Verification is required!!

Exit
EN
02:33

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device
12
Service Name
12-Storage
AE Title
Port
104
Maximum Retries
3
Interval Time(Sec)
15
Timeout(Sec)
15
Cine Zoom Mode
Original
Compression Mode
RLE
Compression Ratio
Lossless
Color Mode
Color
☒ Allow Multiframe
Max Framerate
35
SR Storage Option

Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements
Not Store SR
12-Storage
104
N

Add
Cancel

Service List

Device
1
12

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33

26.18. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

DICOM Service

Storage
Print
Worklist
MPPS
StorageCommitment
Query/Retrieve

Configure the New Service

Device12Service Name12-StorageAE TitlePort104

Maximum Retries3Interval Time(Sec)15Timeout(Sec)15

Cine Zoom ModeOriginal
Compression ModeRLE
Compression RatioLossless

Color ModeColor
☒ Allow Multiframe
Max Framerate35

SR Storage Option

Add
Cancel

Not Store SR
Attach SR When Store Images
Attach SR When Storing Images and SR Contains User-defined Measurements
Only Store SR
Only Store SR and It Contains User-defined Measurements
Not Store SR

Service List

Device
112

104
N

Delete
Default
Verify
Verification is required!

Exit
EN
02:33

26.19. Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)




26.20. Для режима панорамного сканирования (iScape View)




26.21. Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)



26.22. Для анатомического М-режима (Free Xros M)

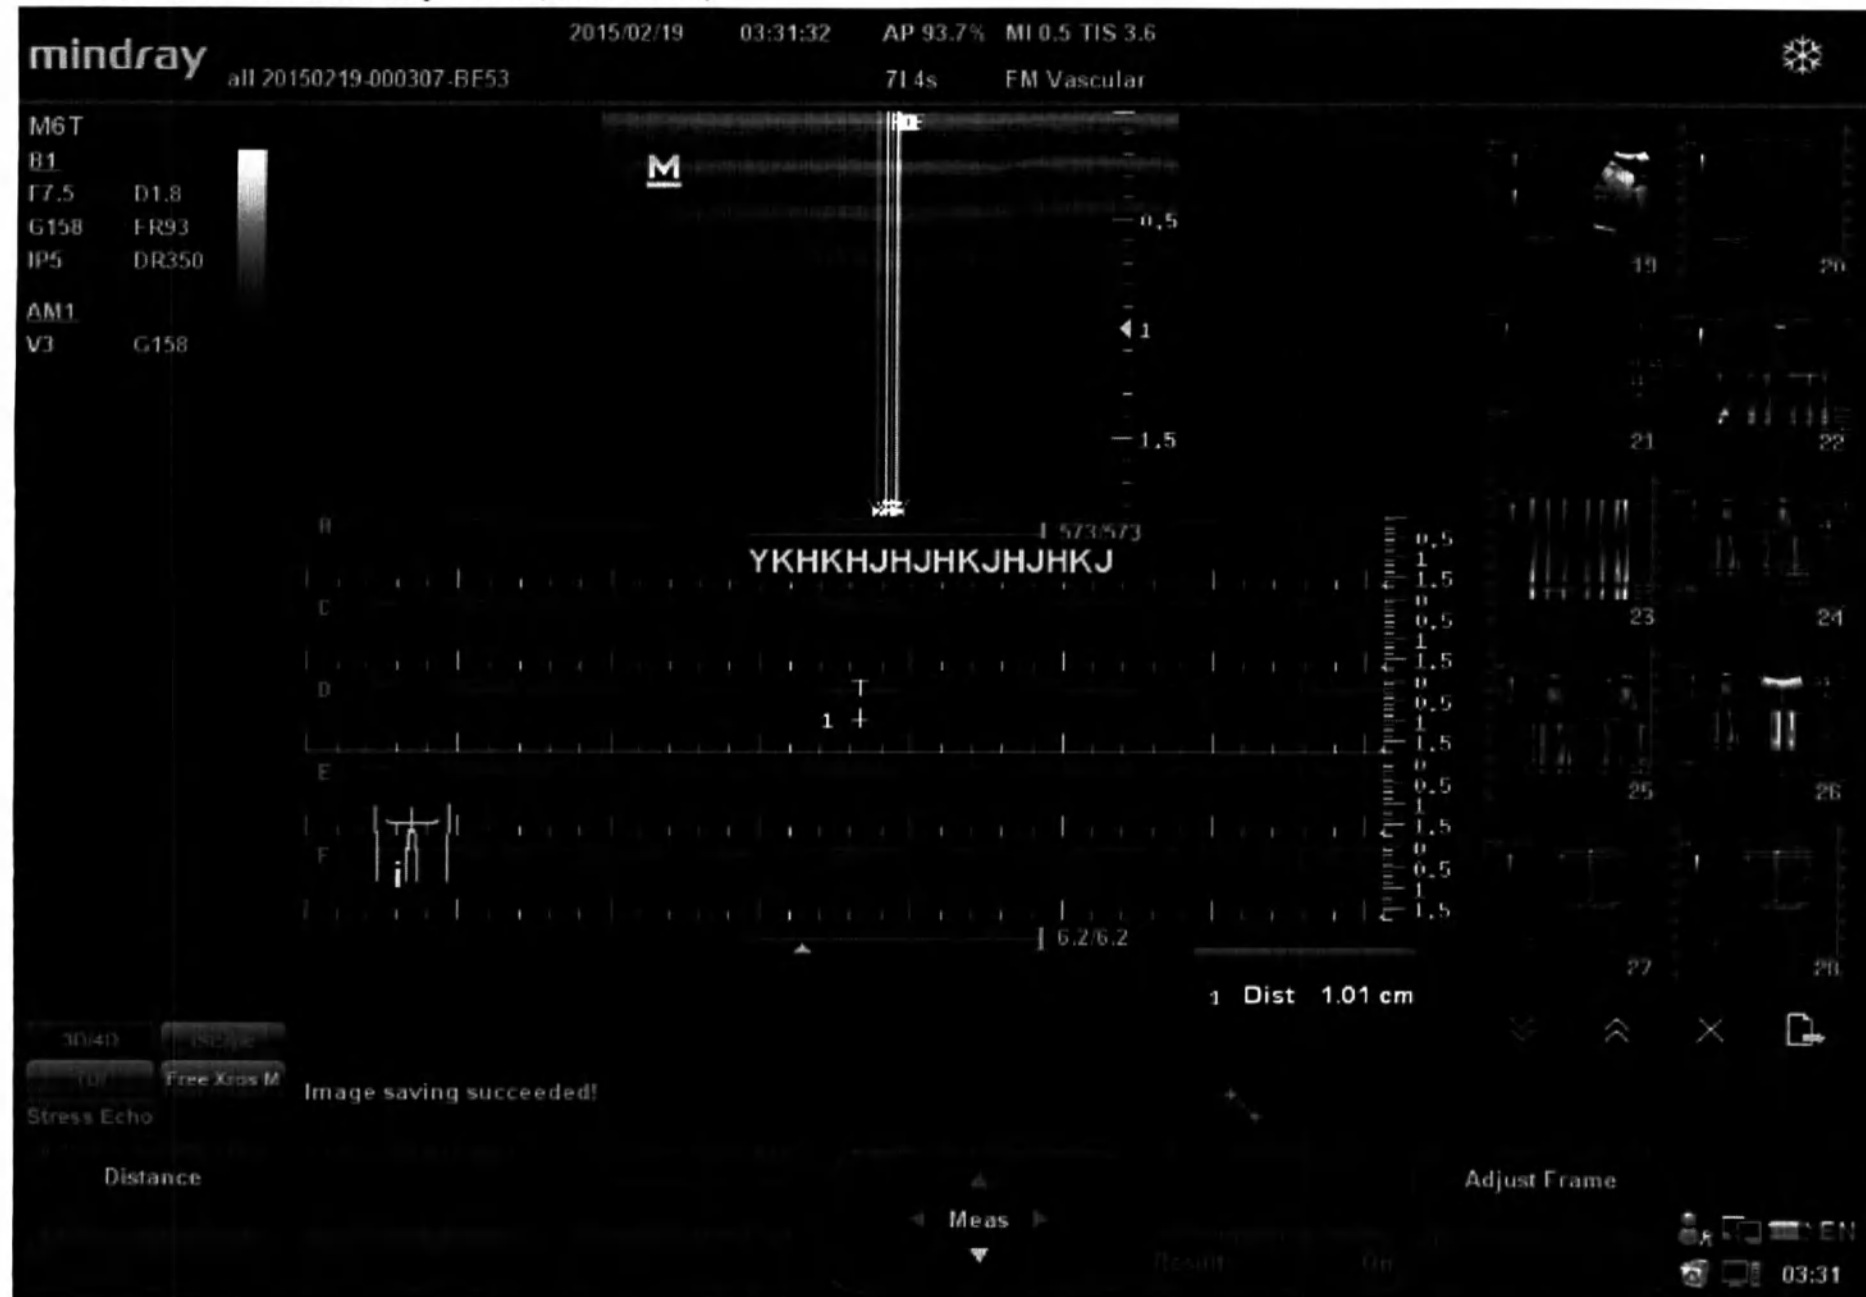

26.23. Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)

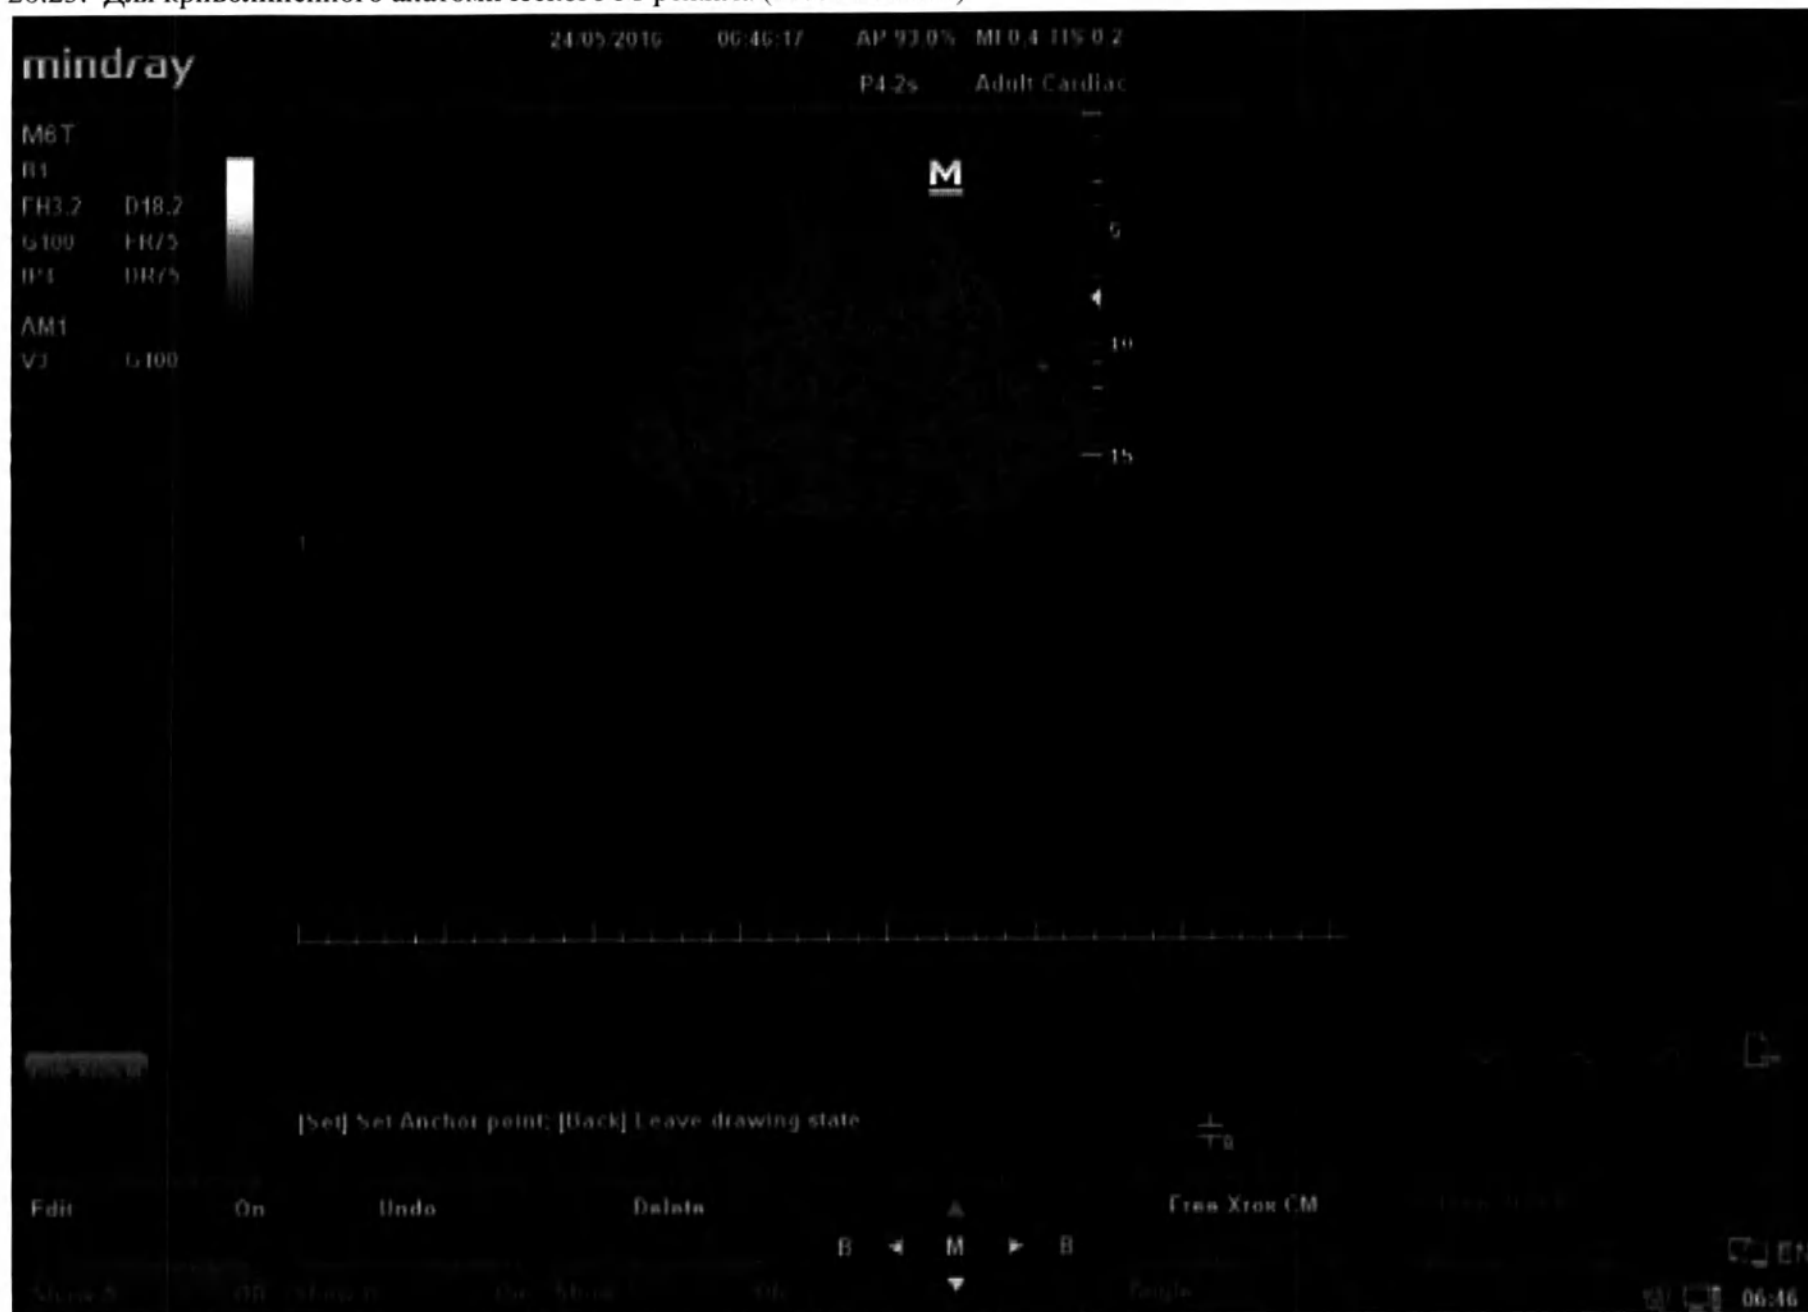

26.24. Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)



26.25. Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)





26.27. Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)



26.28. Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)



26.29. Для улучшения качества изображения путем подавления спекл-шумов и улучшения контрастного разрешения (iClear)



Body Mark Preset

Exam Mode: Softkey

Library Name:


Available Items: Selected Items:

		Default
		Probe

User defined Load Factory OK Cancel


04:30

26.31. Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantitative Analysis)

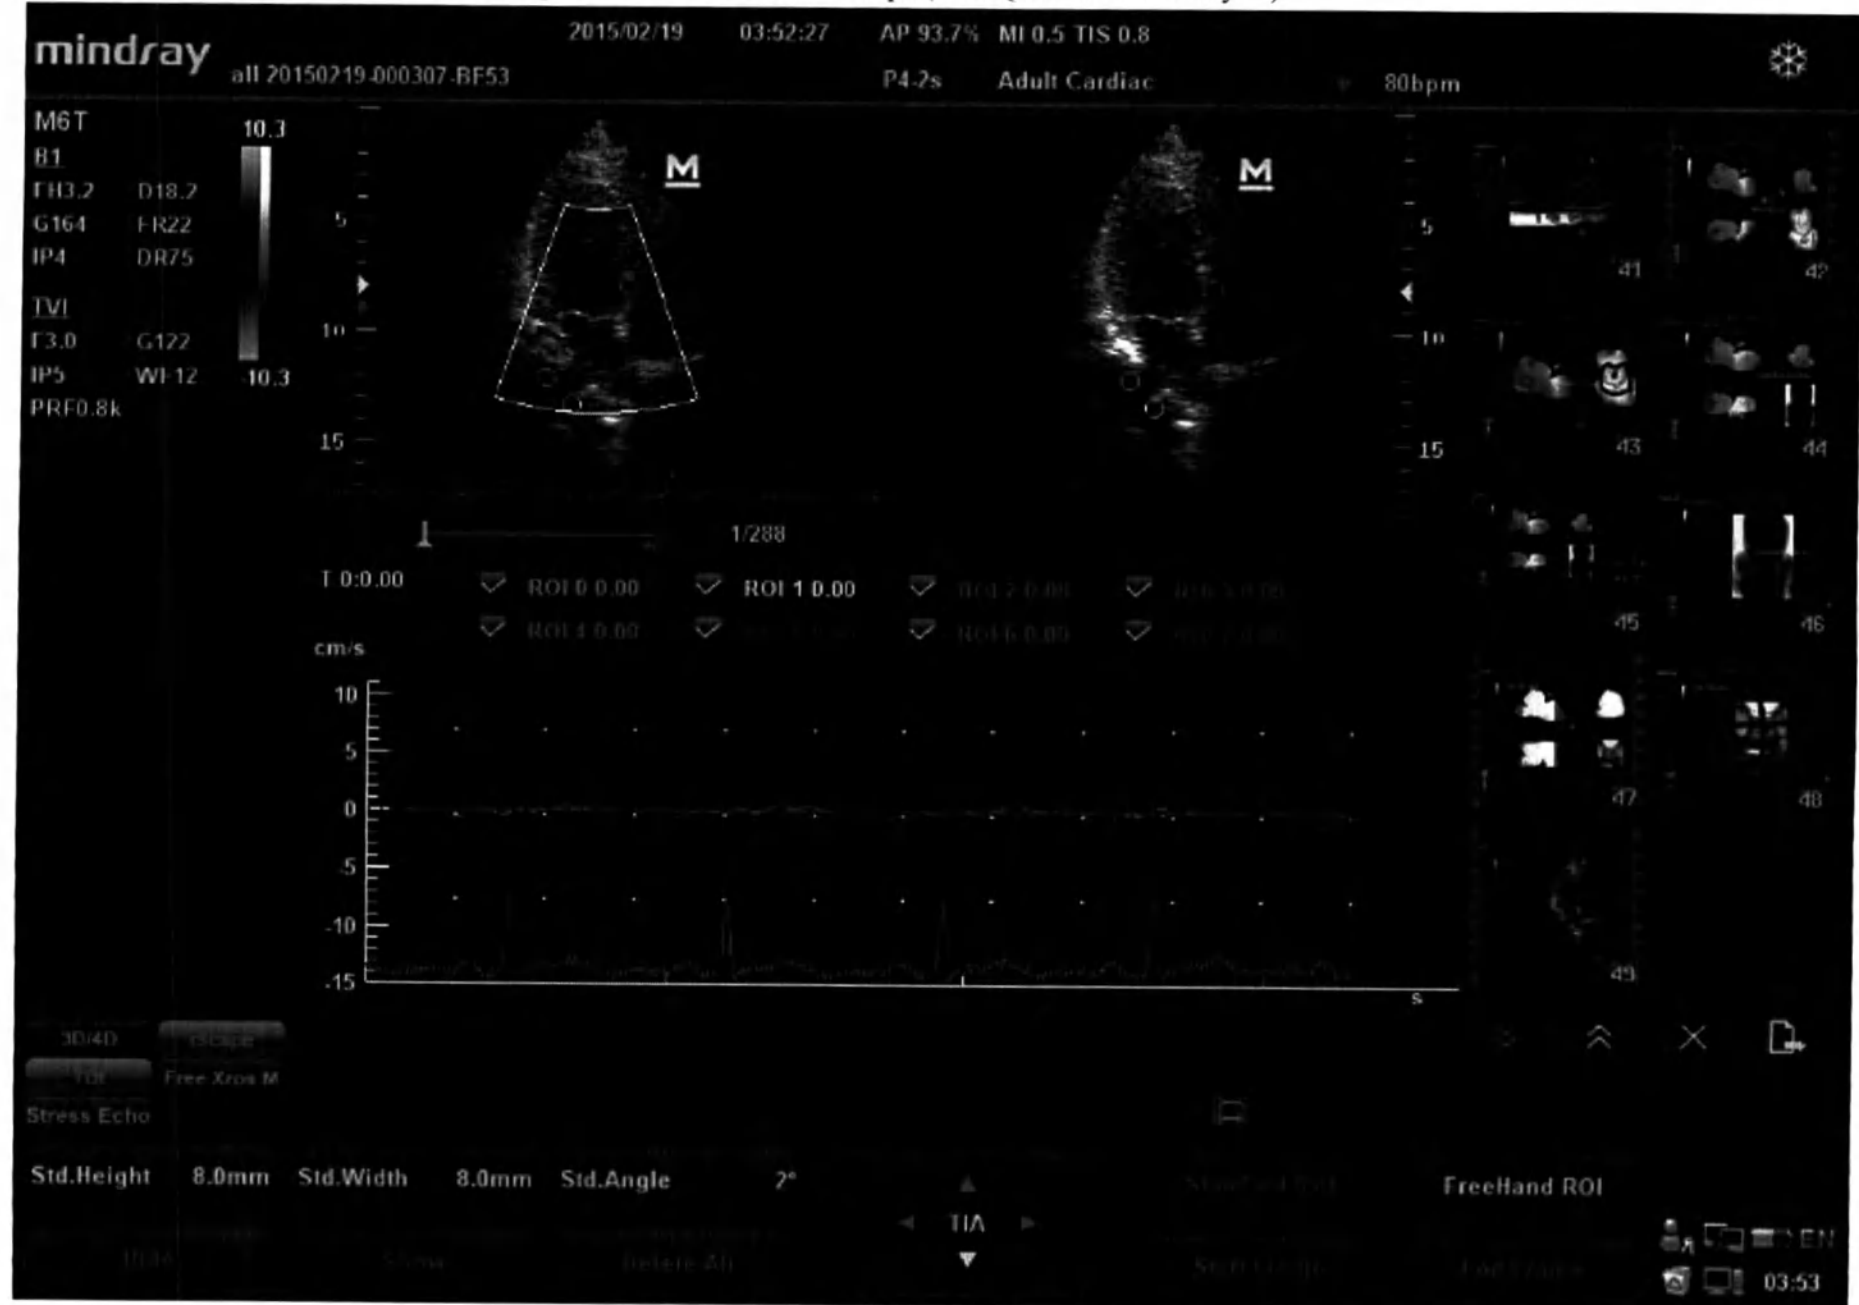



27. Модули:

27.1. Модуль ЭКГ (ECG Module)

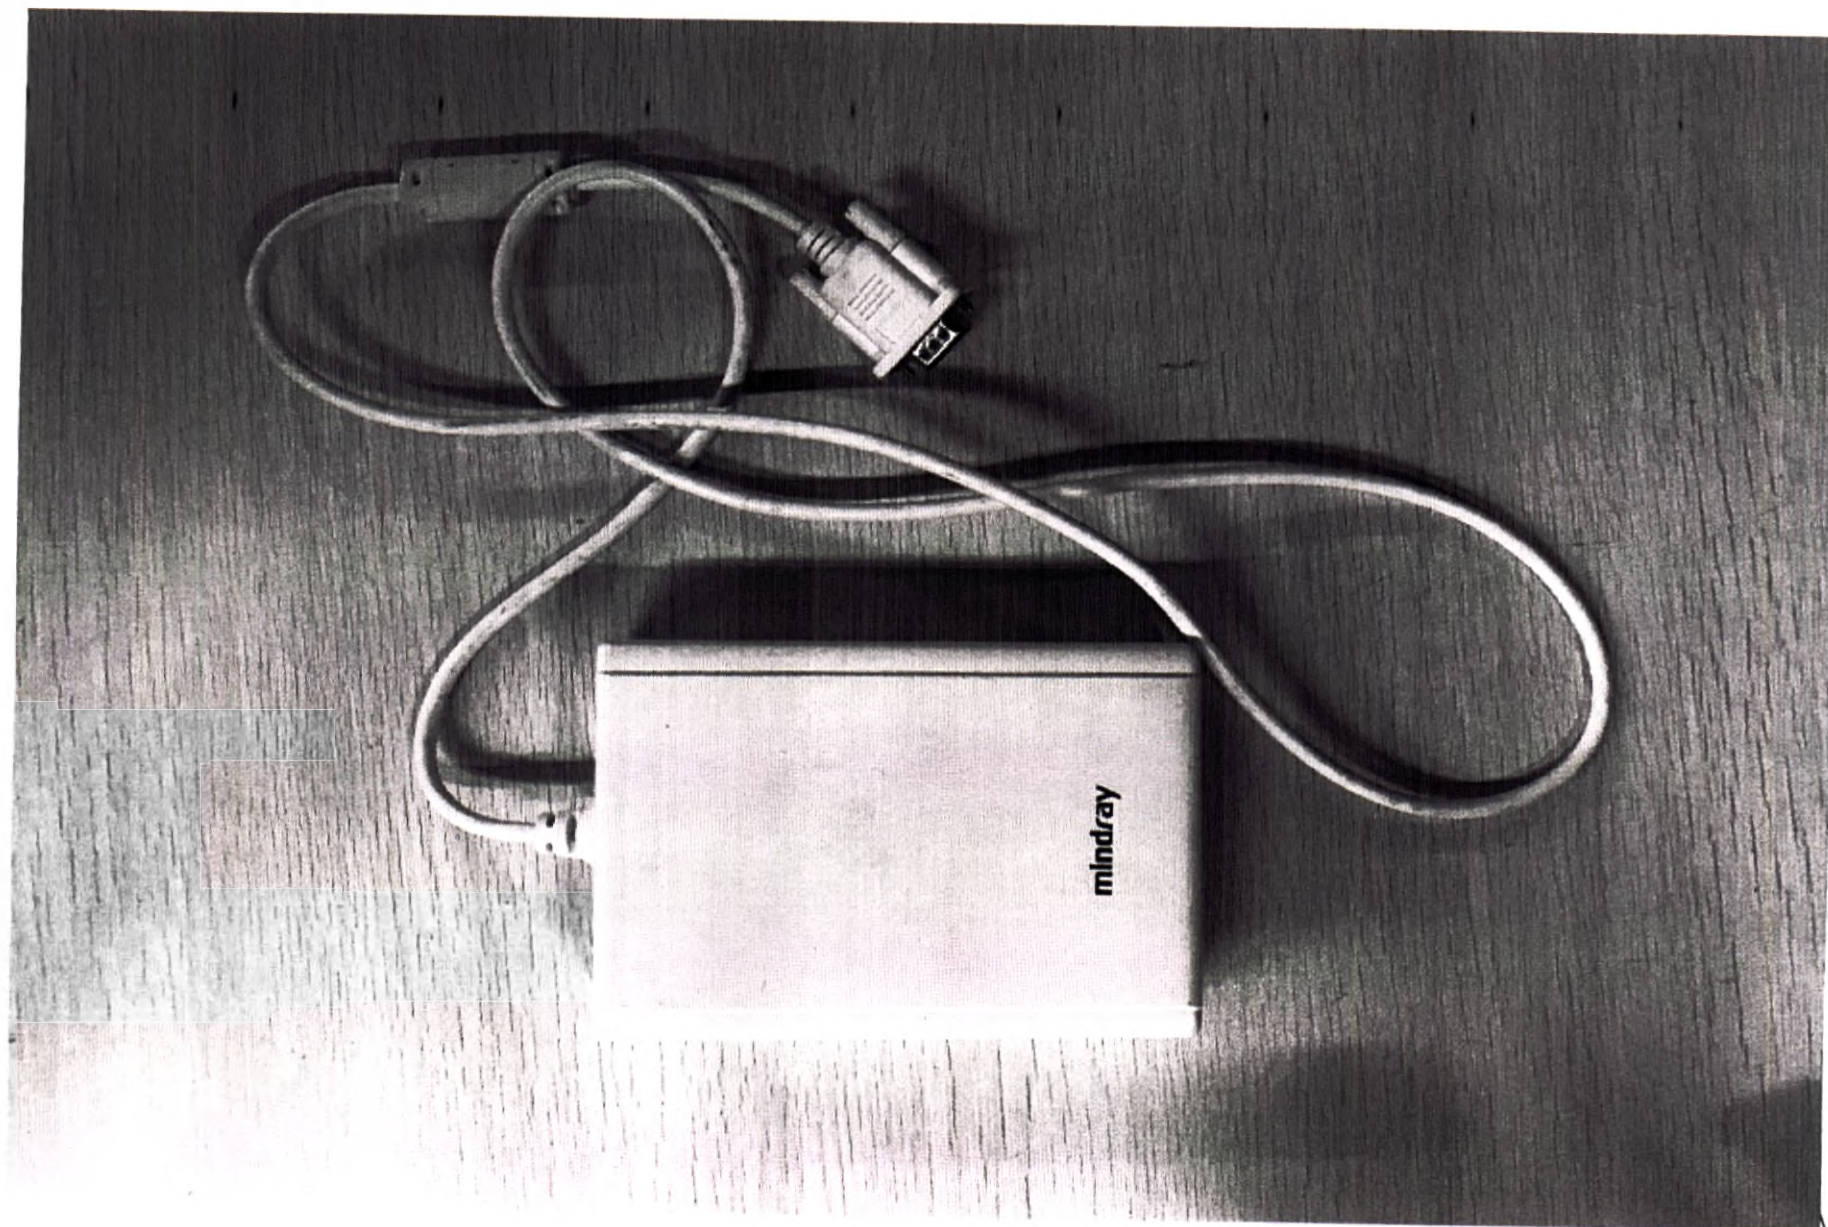




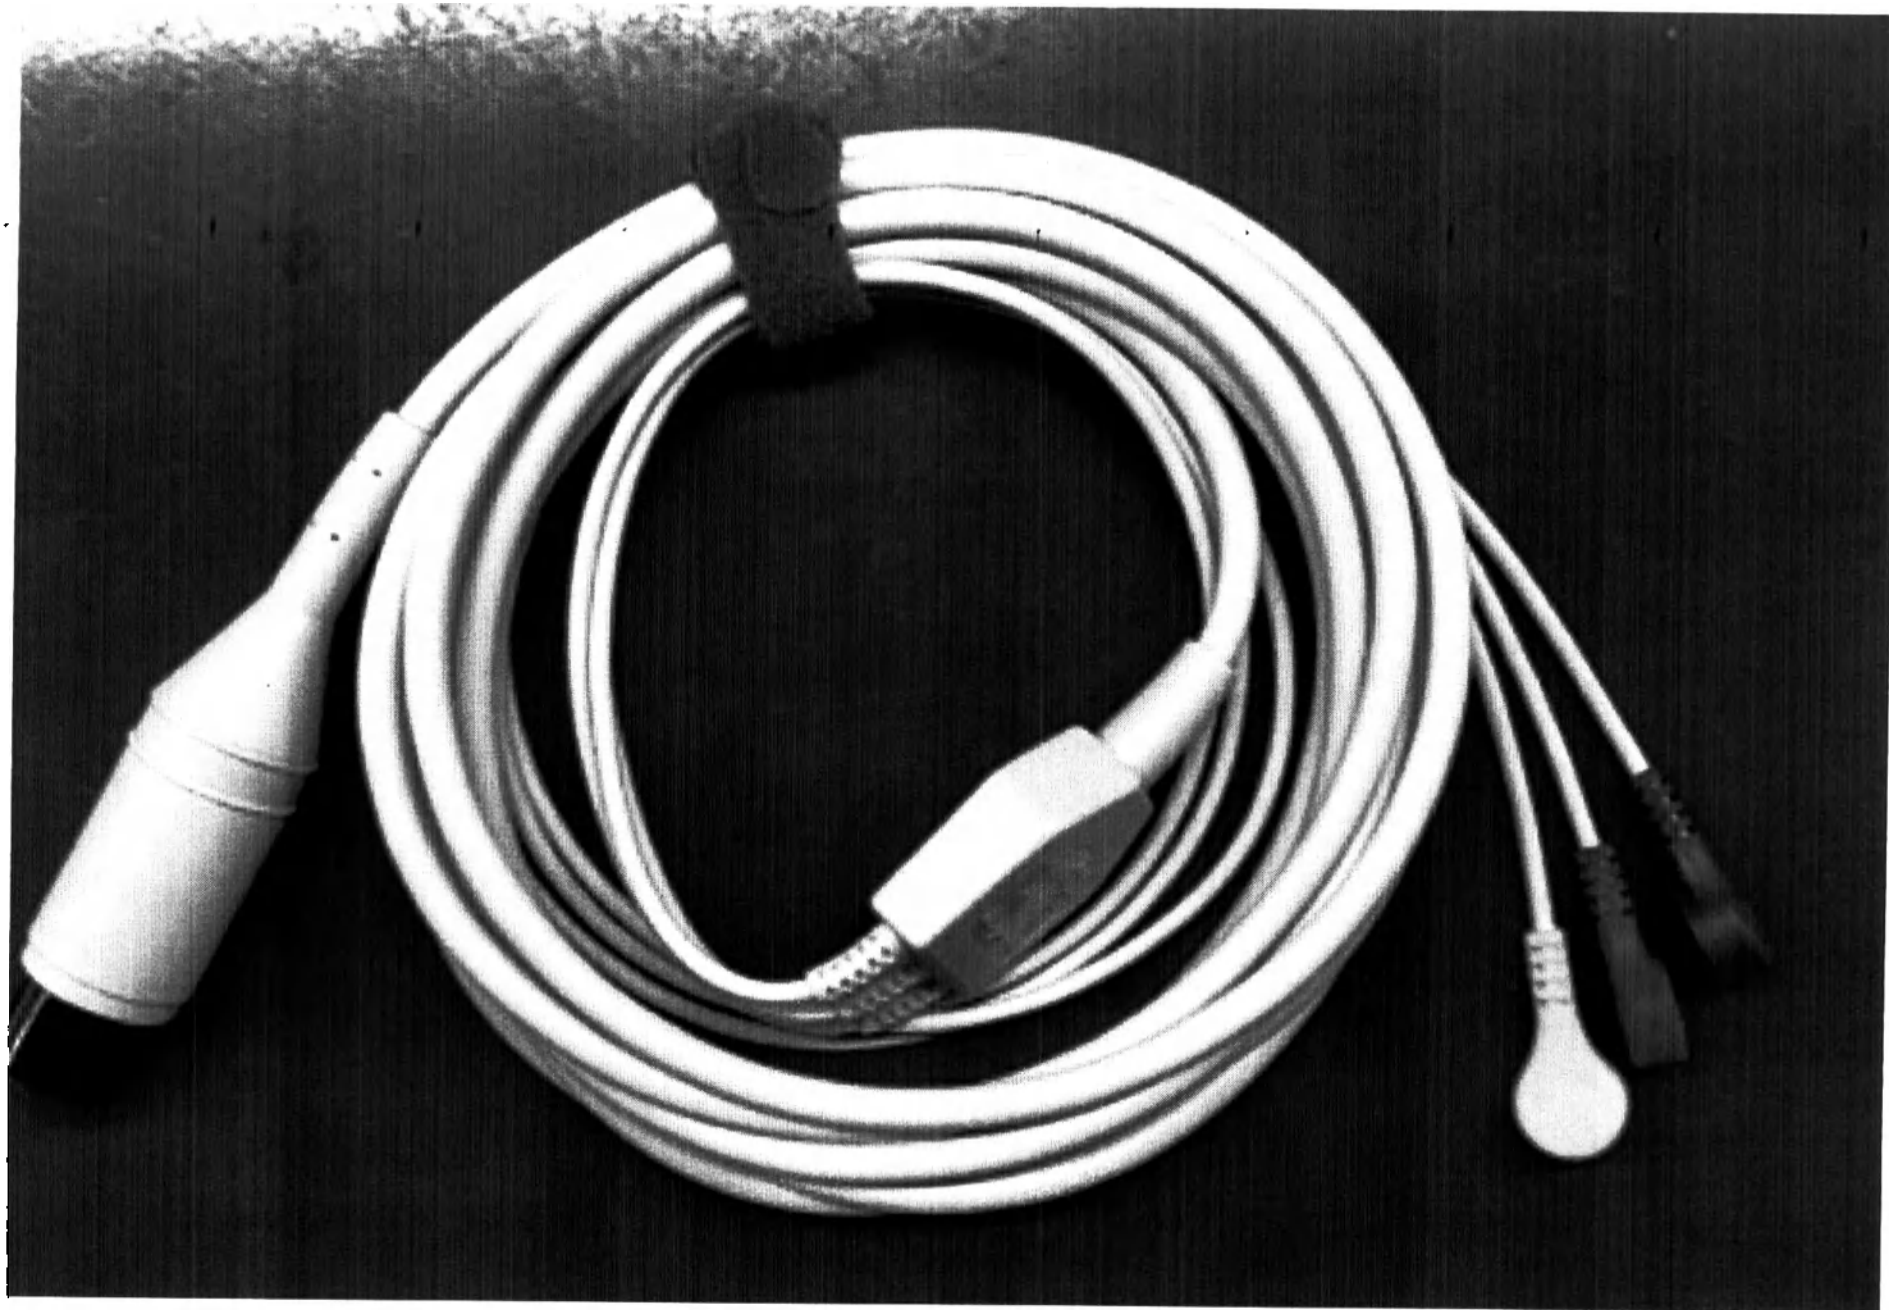

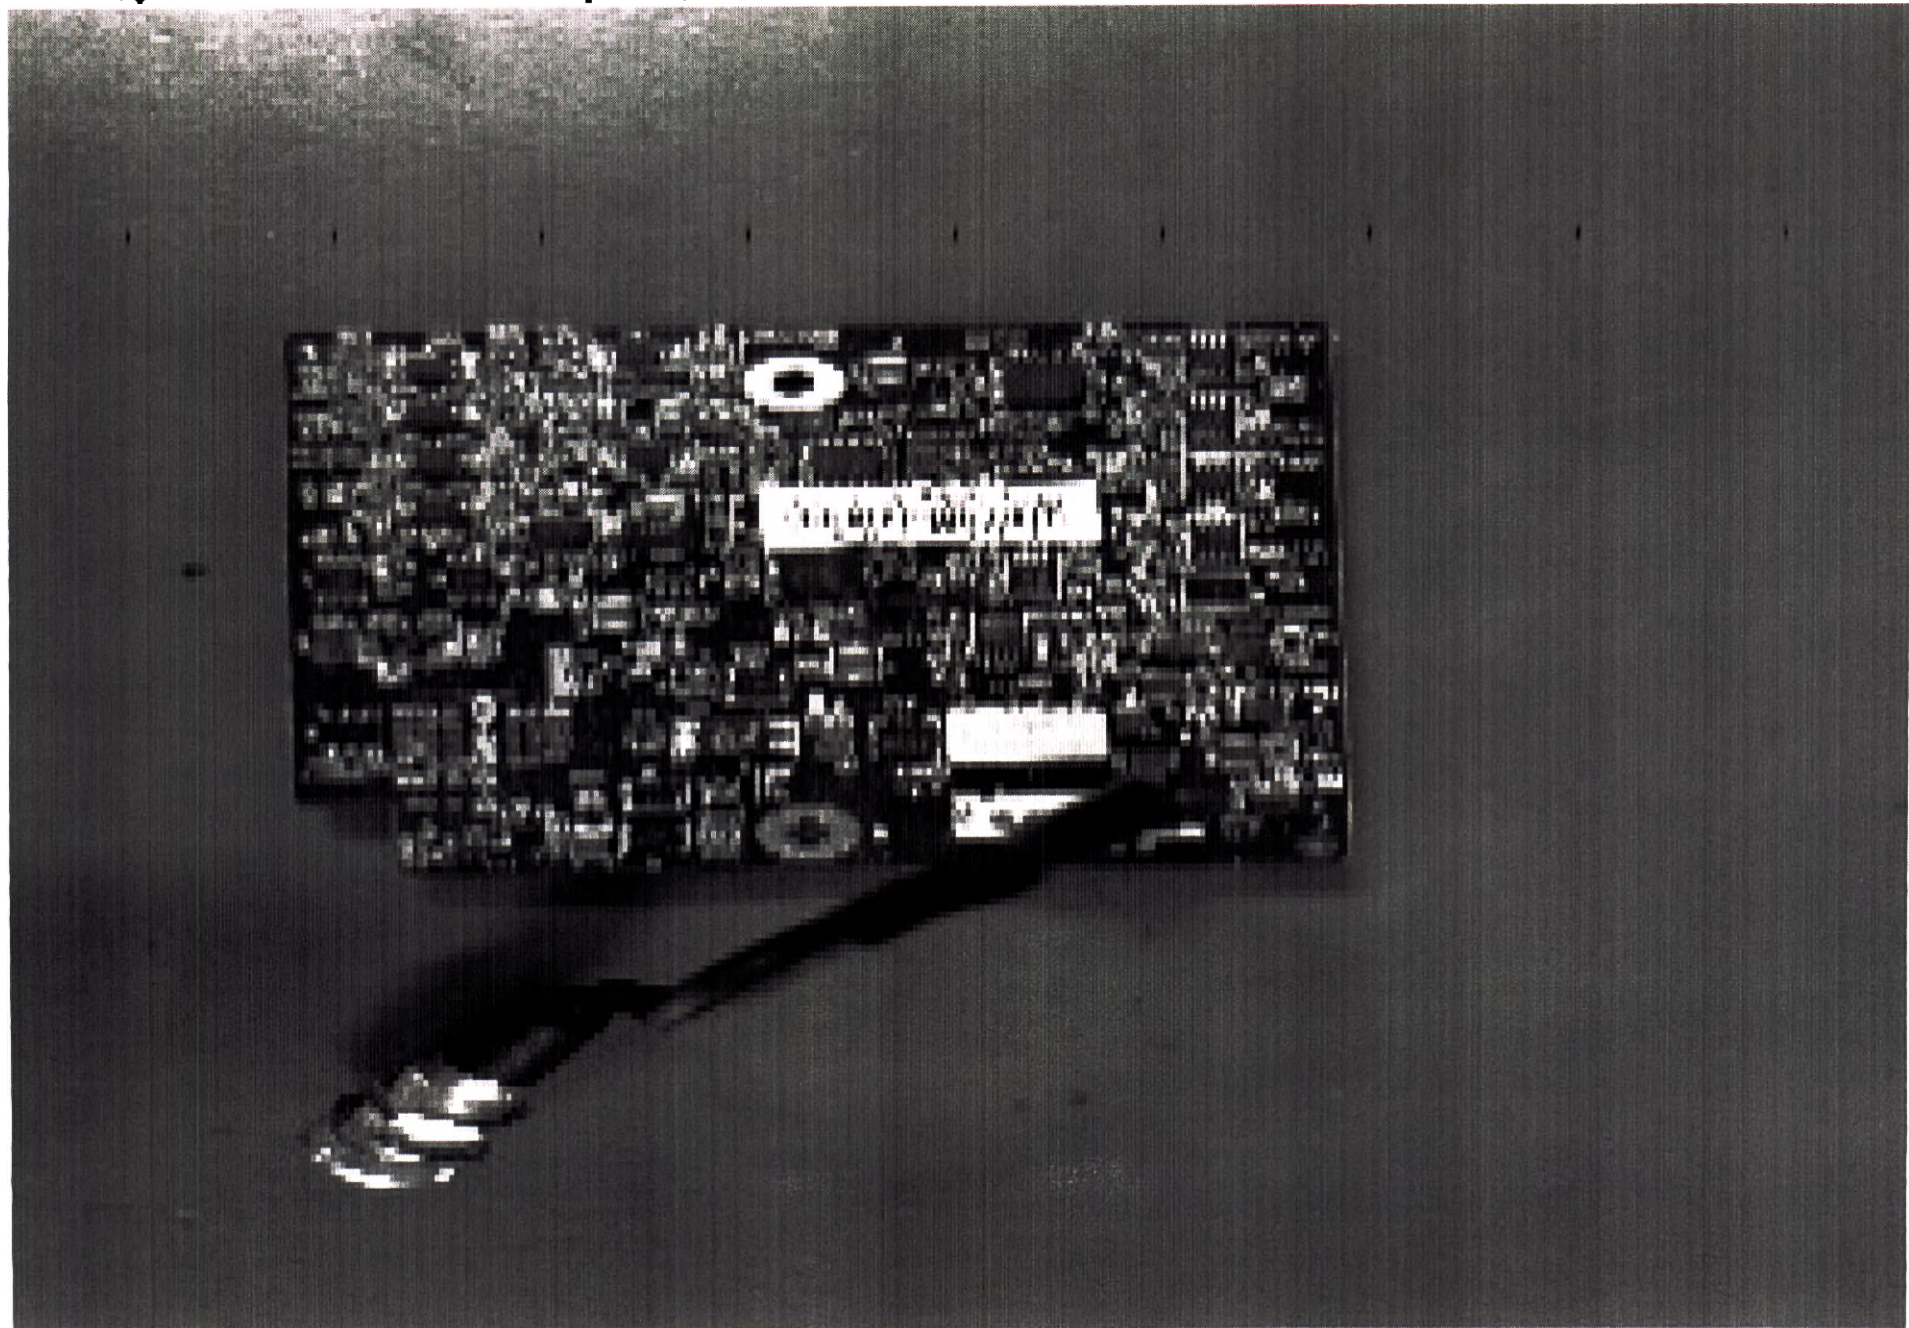



27.5. Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D/TEE Assembly)

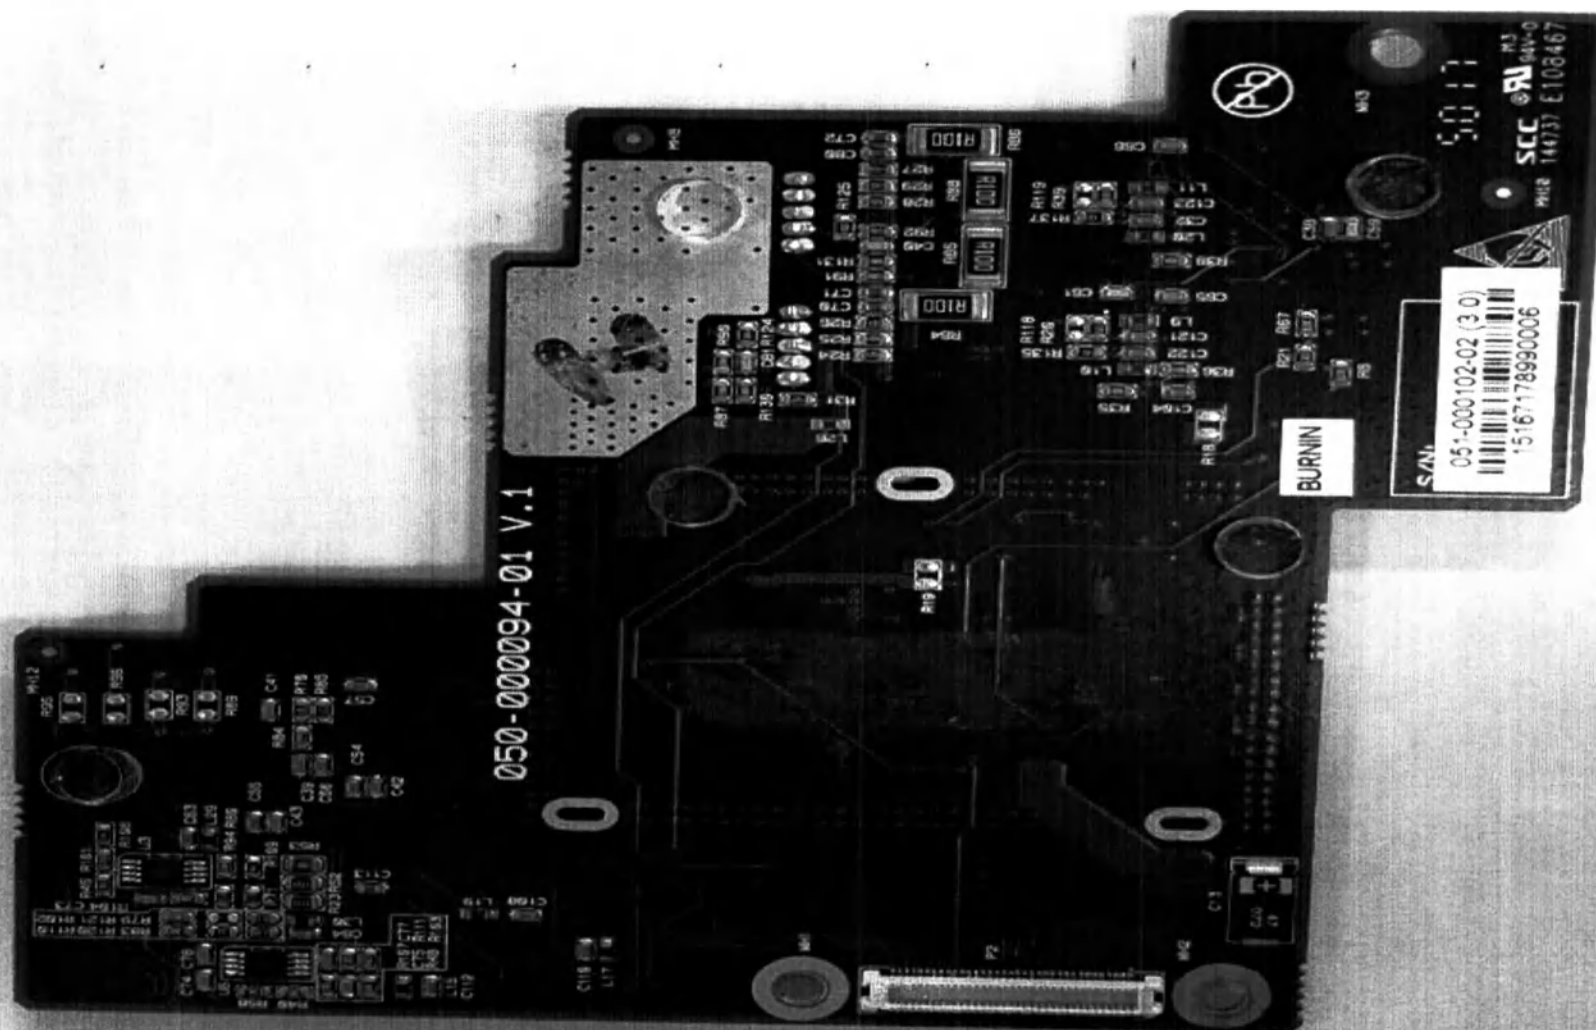



28. Тележки

28. 1 . Тележка мобильная UMT-300

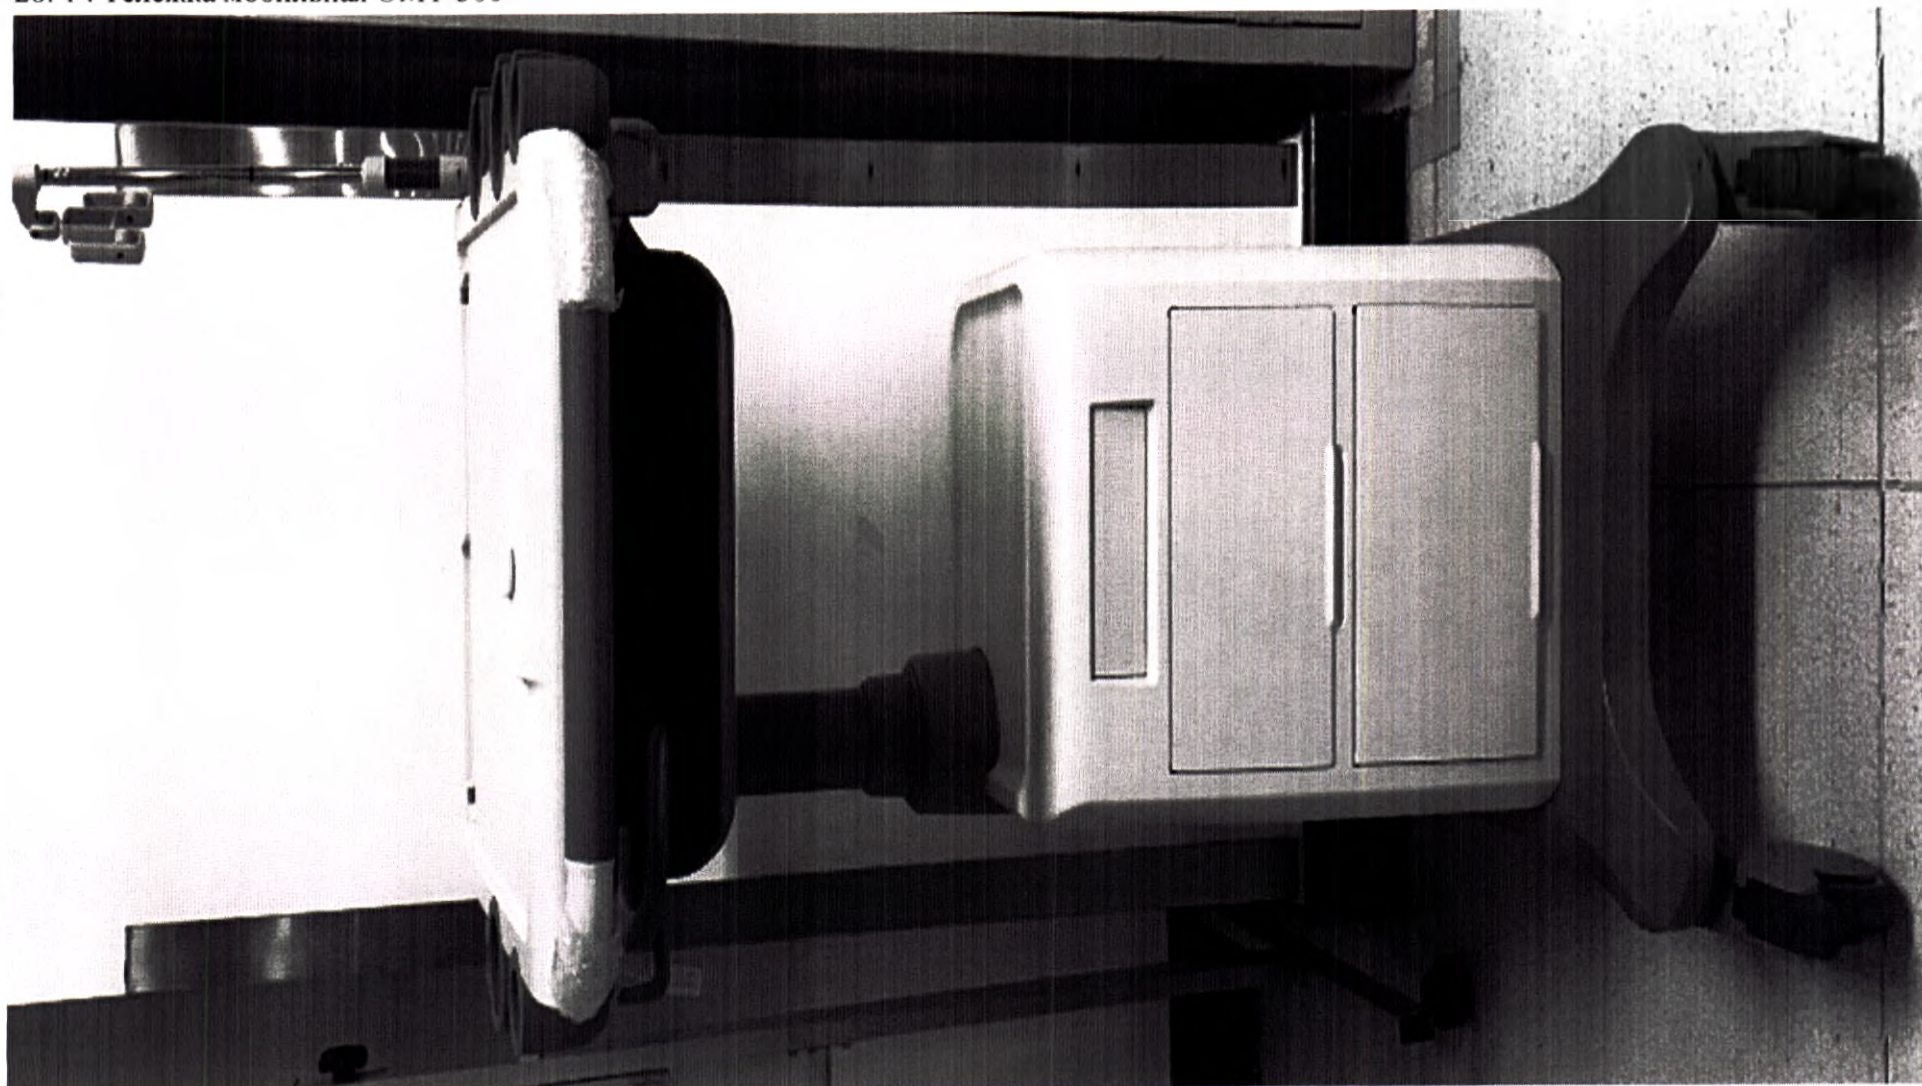

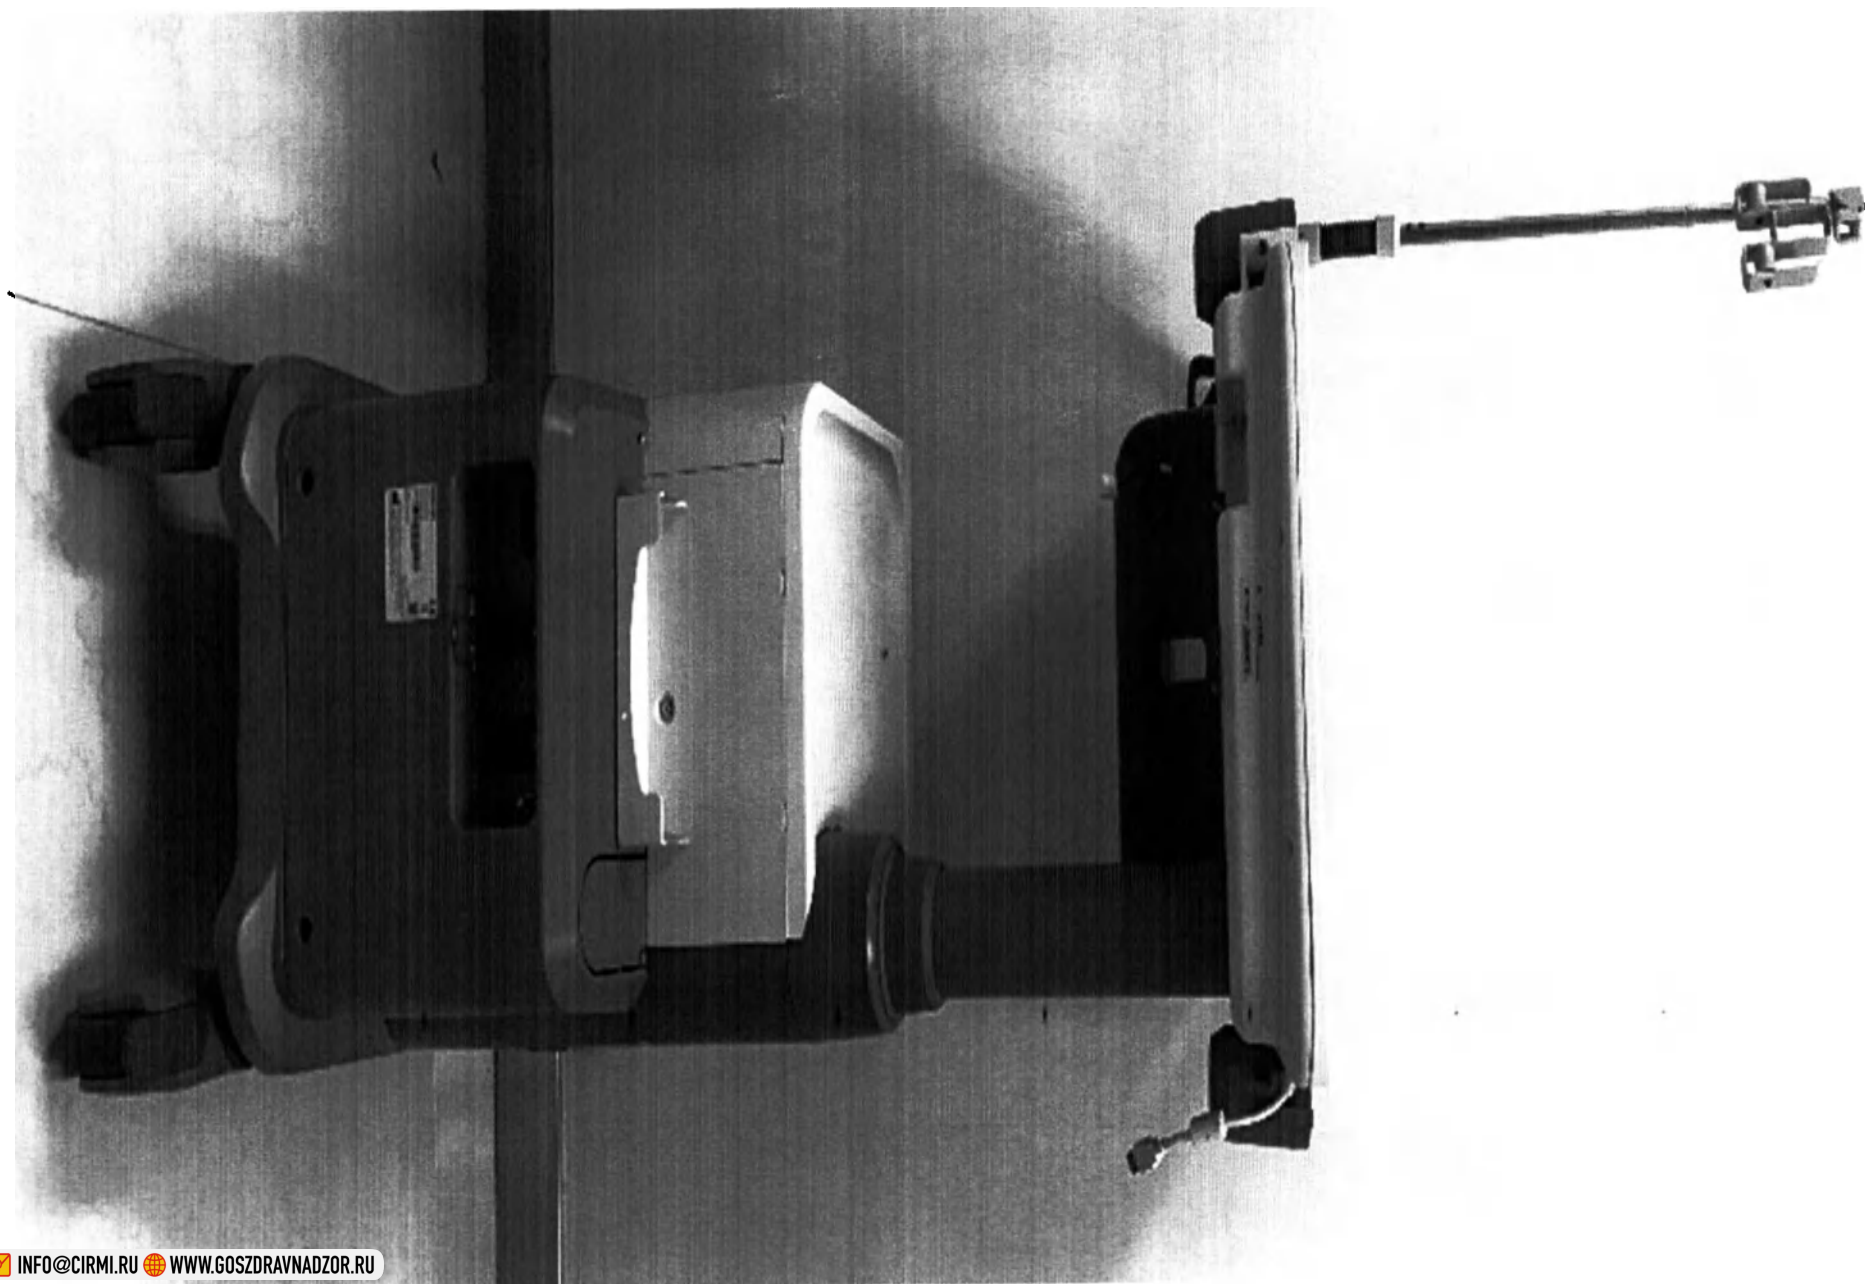


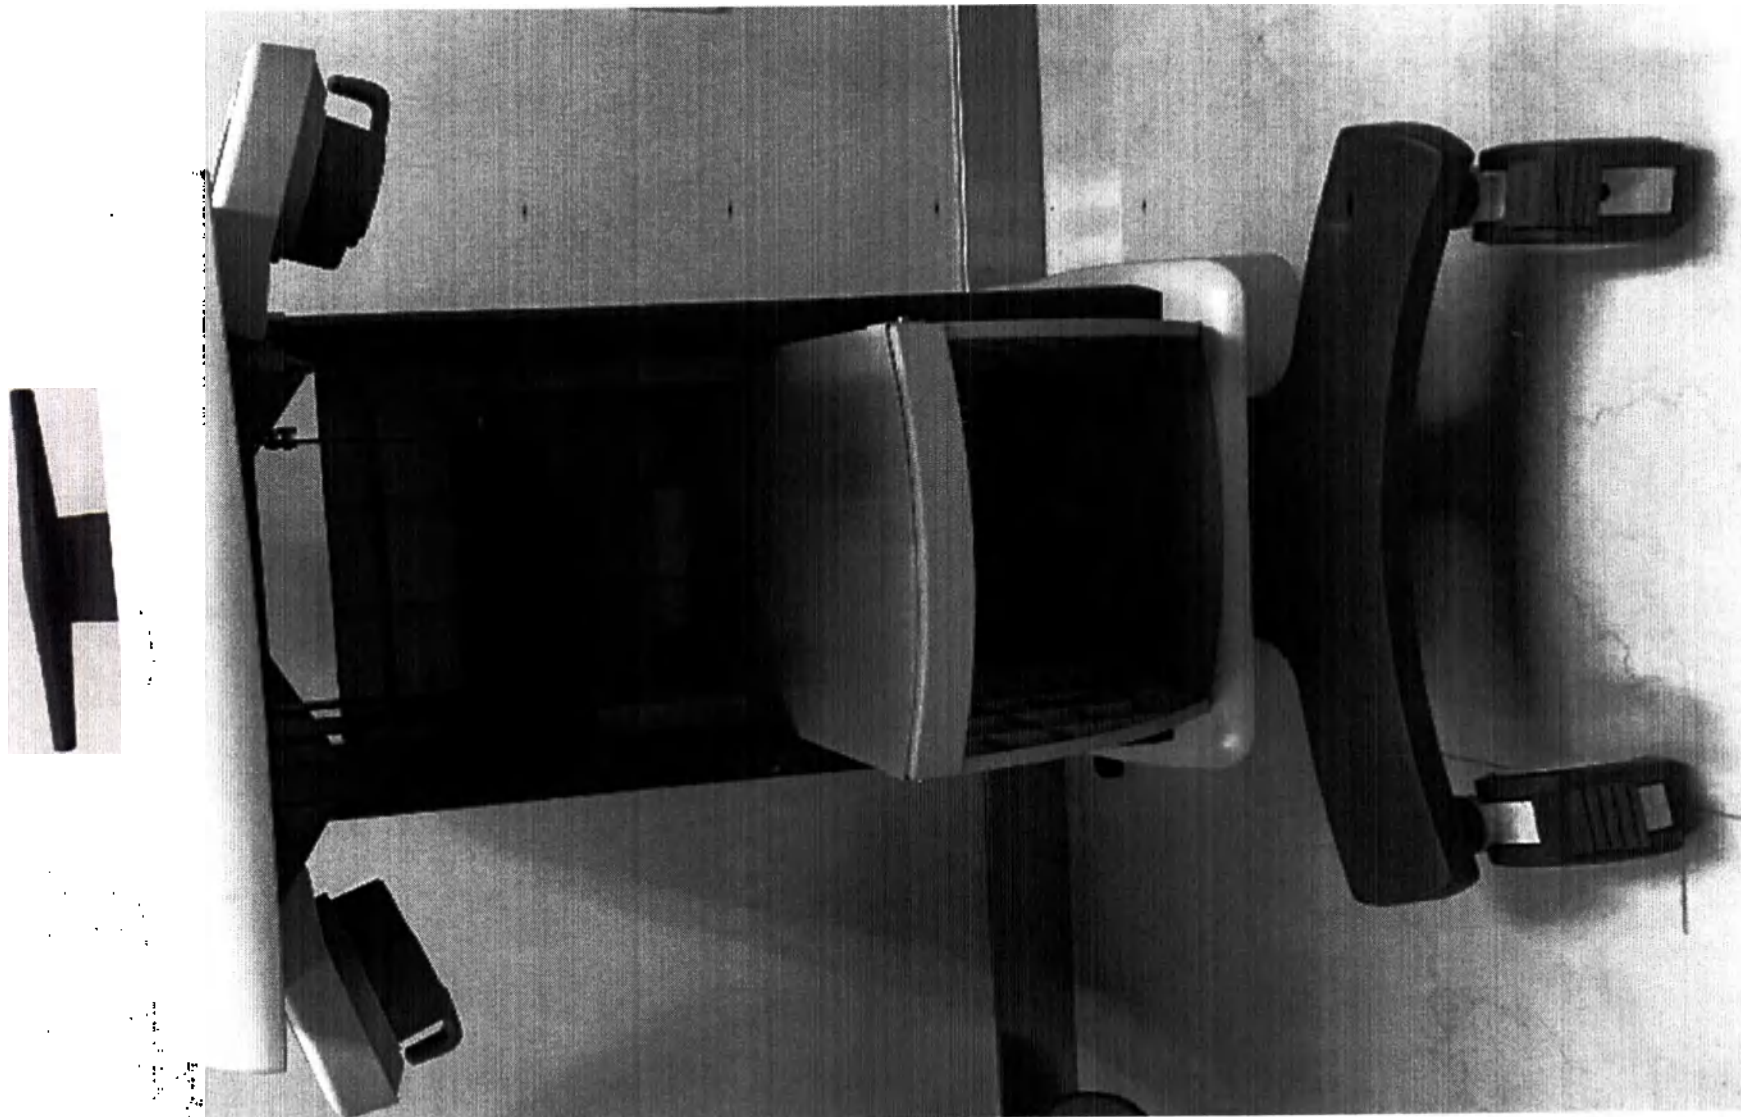

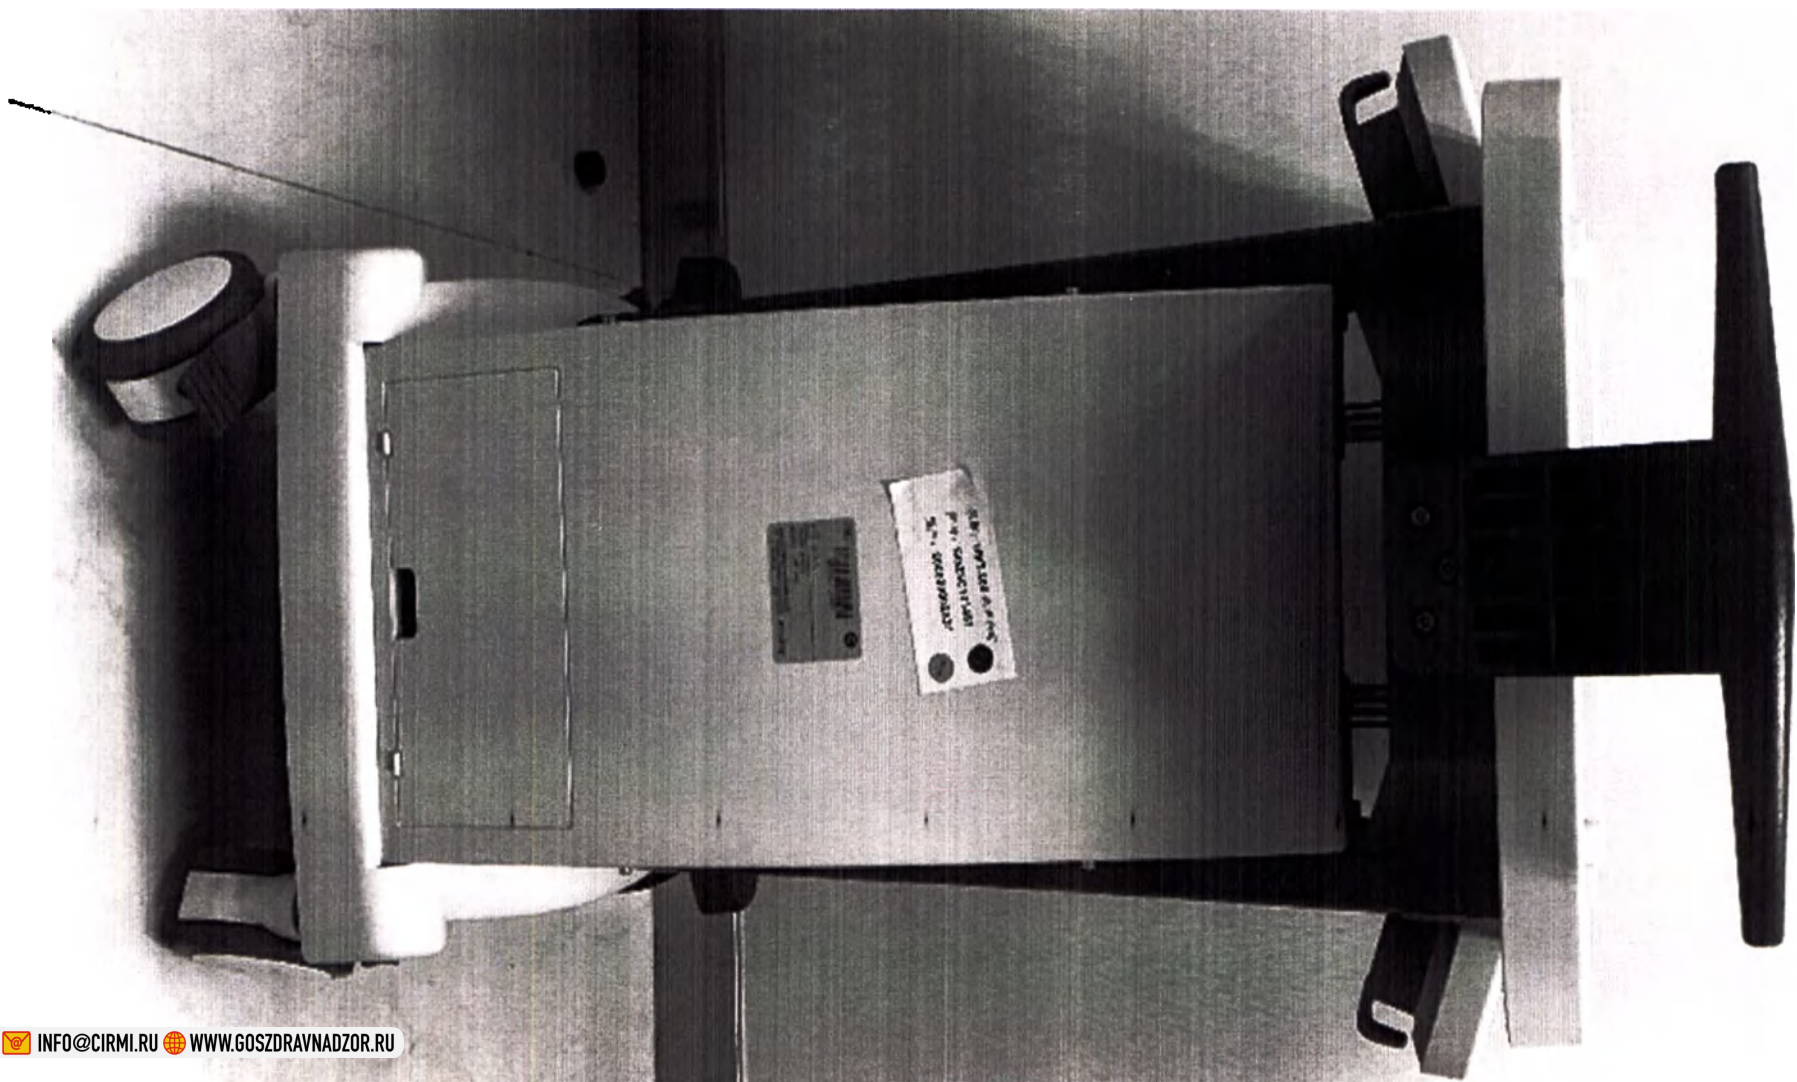

Принадлежности:

1. Ножной переключатель, 2 клавиши

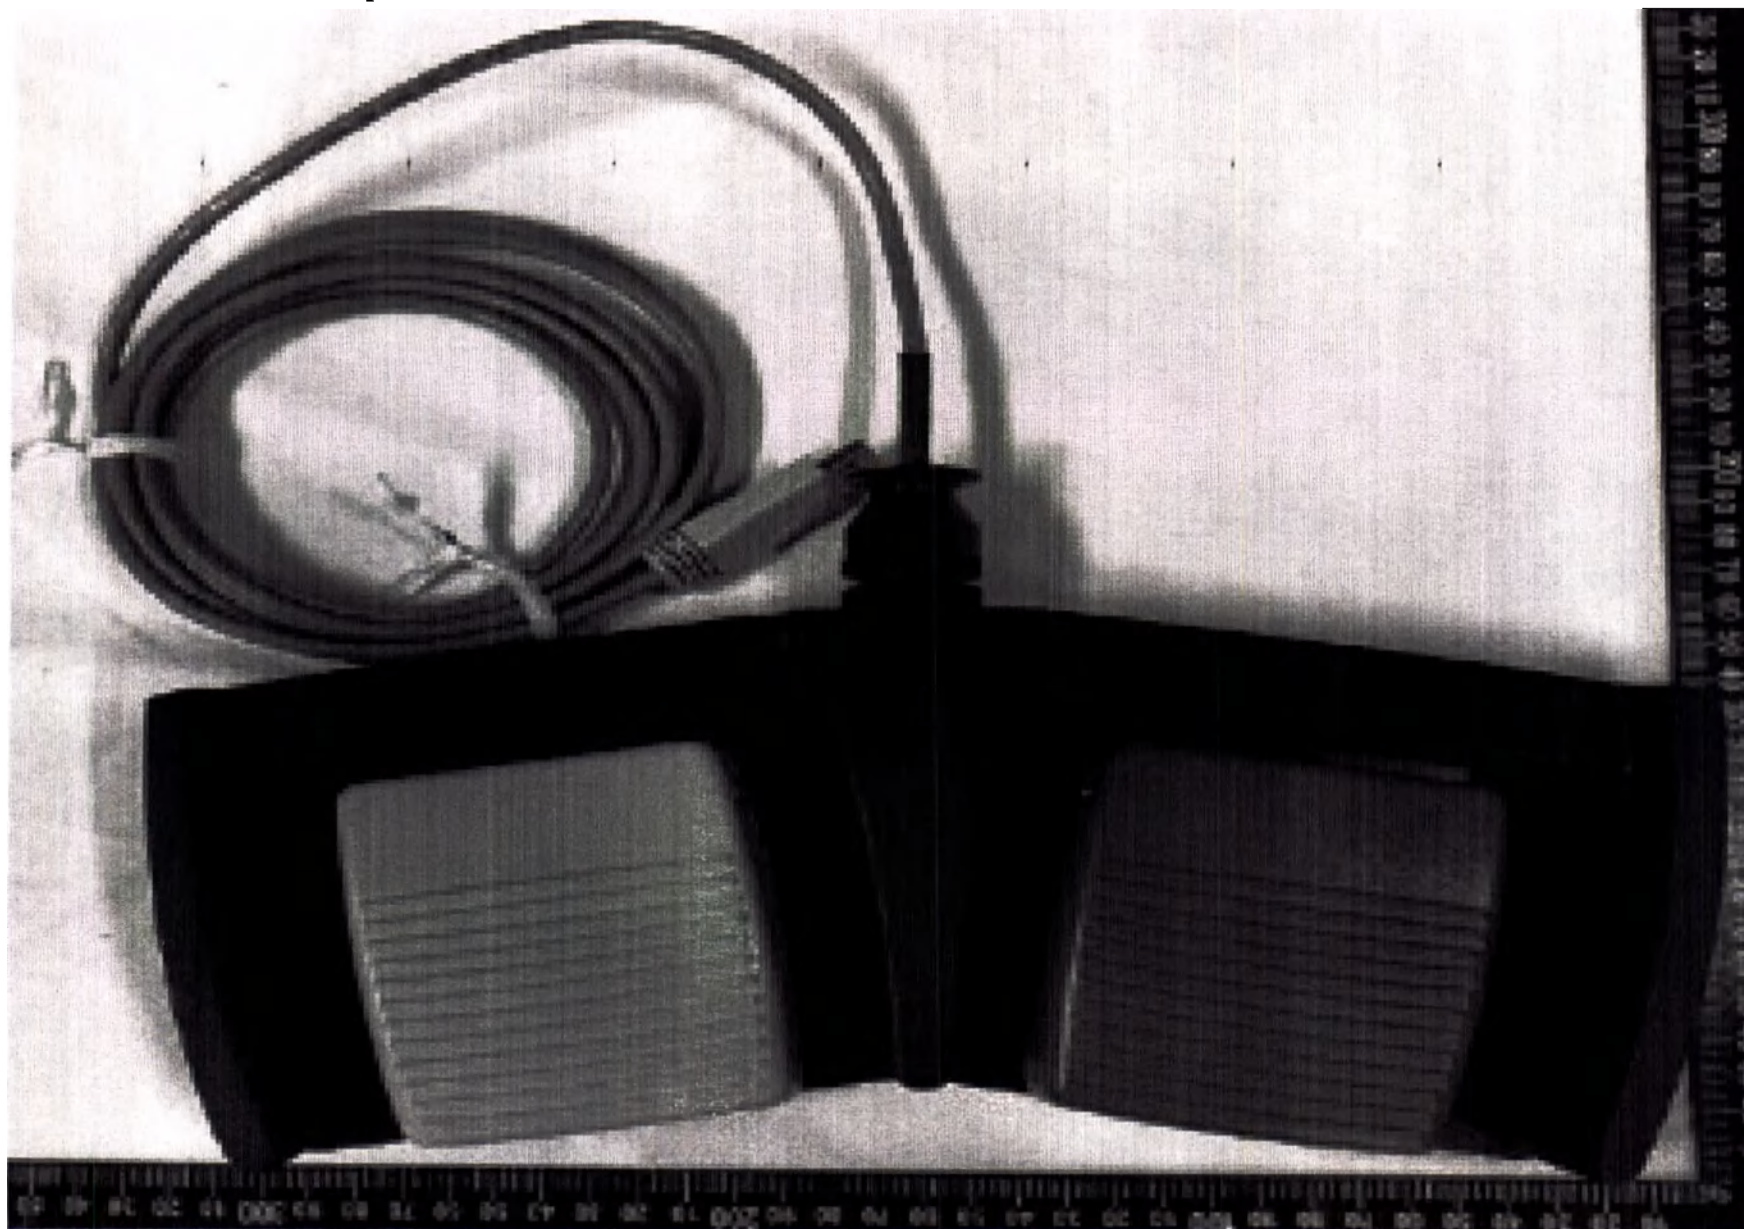

Прошито 654 лист а

Генеральный директор
ООО "Миндрей Медикал Рус"
Сюнь Вей Сюнь Вей



по

11.05.21г

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор
ООО "Миндрей Медикал Рус"

(должность)

Сюн Вэй

(ФИО)

(подпись)

М.П.



« ____ » июля 2021 г.

Дополнение фотографические изображения медицинского изделия

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии М с принадлежностями, варианты исполнения:
М6Т, М58, М6, М6 Exp, М6 Pro, М6s**

2021г.

- Этикетка основного блока Системы ультразвуковой визуализации универсальной серии М с принадлежностями, варианты исполнения: М6Т, М58, М6, М6 Exp, М6 Pro, М6s.

mindray

Diagnostic Ultrasound System

Model : XXXXXXXX

SN



XX-XXXXXXXX



XXXXXXXX

12V  9A(MAX.)



0123

2108-20-65821 - 3.0



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray

Diagnostic Ultrasound System

Model :M6T


SN



9X-0A000214



2020-10-11

12V 

9A(MAX.)



0123

2108-20-65821-3.0



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Th
the
ww

Win
Sta
02
X2

Diagnostic Ultrasound System

mindray

Model: XXXXXXXXX

Size: 700mmx530mmx425mm


Qty.: 1 N.W.: 15 kg G.W.:



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




00000000



XXXXXXXX

XXXXXXXX

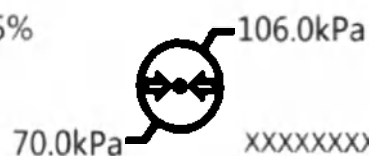

XXXXXXXX



(01)00000000000000

(11)XXXXXX

(21)00000000

W#:



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

XXXXXXXX



XXXXXXXX



0123

047-027366-00(2.0)



- Маркировка датчиков общий вид

Ultrasonic Transducer

MODEL: XXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX

CE⁰¹²³

IPX7




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Ultrasonic Transducer

MODEL: XXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX

CE⁰¹²³ **IPX7**



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

- Маркировка Датчиков, биопсийных насадок, тележки в виде наклейки на упаковке

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: XX-XX

Qty.: 1

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

N.W.: XXX kg G.W.: XXX kg

Ordering No.:



XX-XXXXXXXXXX

W#



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

SN




XX-XXXXXXXXXX






XXXX-XX-XX



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

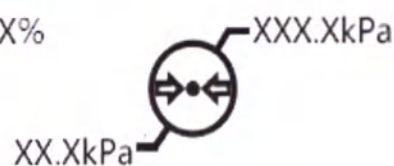

047-027962-00(1.0)


- Маркировка тележки

mindray

Mobile Trolley

Model :

SN



047-028743-00(1.0)

N.W.:21kg

Max.W.(Loaded):45kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

- Макет этикетки на русском языке:

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии М с принадлежностями, вариант исполнения: XXX
Модель: XXX

EAC

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года

 «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «Миндрей Медикал Рус»



Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,
антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com

- Сумка

в которые Допускается, перед упаковкой в картонные коробки, упаковывать датчики



- Кейс

Используют для транспортировки датчиков






- Кейс для транспортировки



- Основная схема упаковки устройства выглядит следующим образом

№	Наименование материала	Примечания
1.	Полиэтиленовая пена внутри транспортировочного кейса	Содержит основное устройство, аккумуляторные блоки, удлинители датчиков, адаптеры, шнуры питания, соединители
2.	Защитные коврики	Защита основного устройства
3.	Зазор транспортировочной коробки	Содержит датчики, поставляемые с основным устройством (до 4шт.)
4.	Защитный пенопласт транспортировочной коробки	Защищает транспортировочный кейс и содержит различные принадлежности
5.	Защитный пенопласт сверху транспортировочного кейса	Защищает транспортировочный кейс и содержит различные принадлежности
6.	Картонная крышка транспортировочной коробки	Защищает транспортировочную коробку

1 Защитные коврики , 2 Полиэтиленовая пена внутри транспортировочного кейса

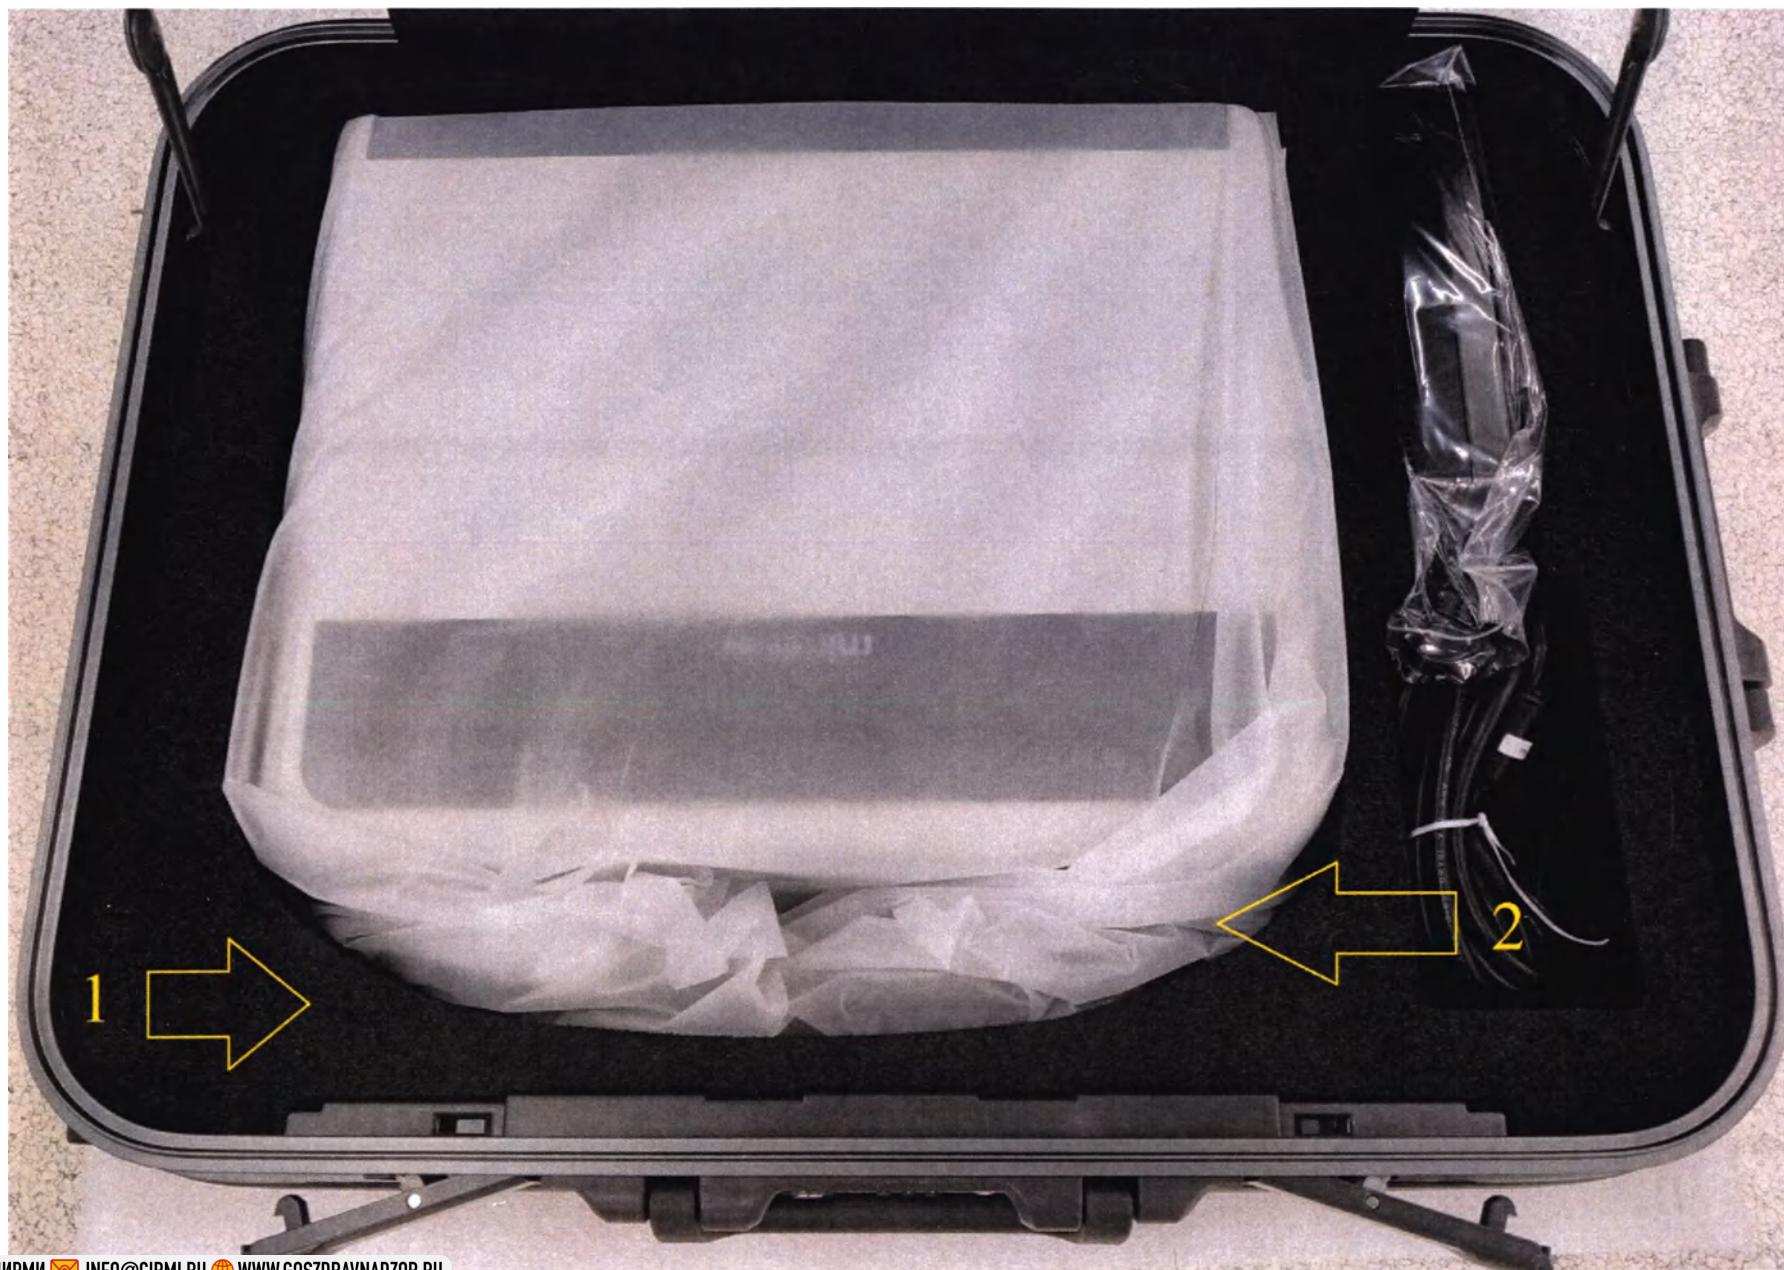


3 Зазор транспортировочной коробки



4. Защитный пенопласт транспортировочной коробки



5 Защитный пенопласт сверху транспортировочного кейса

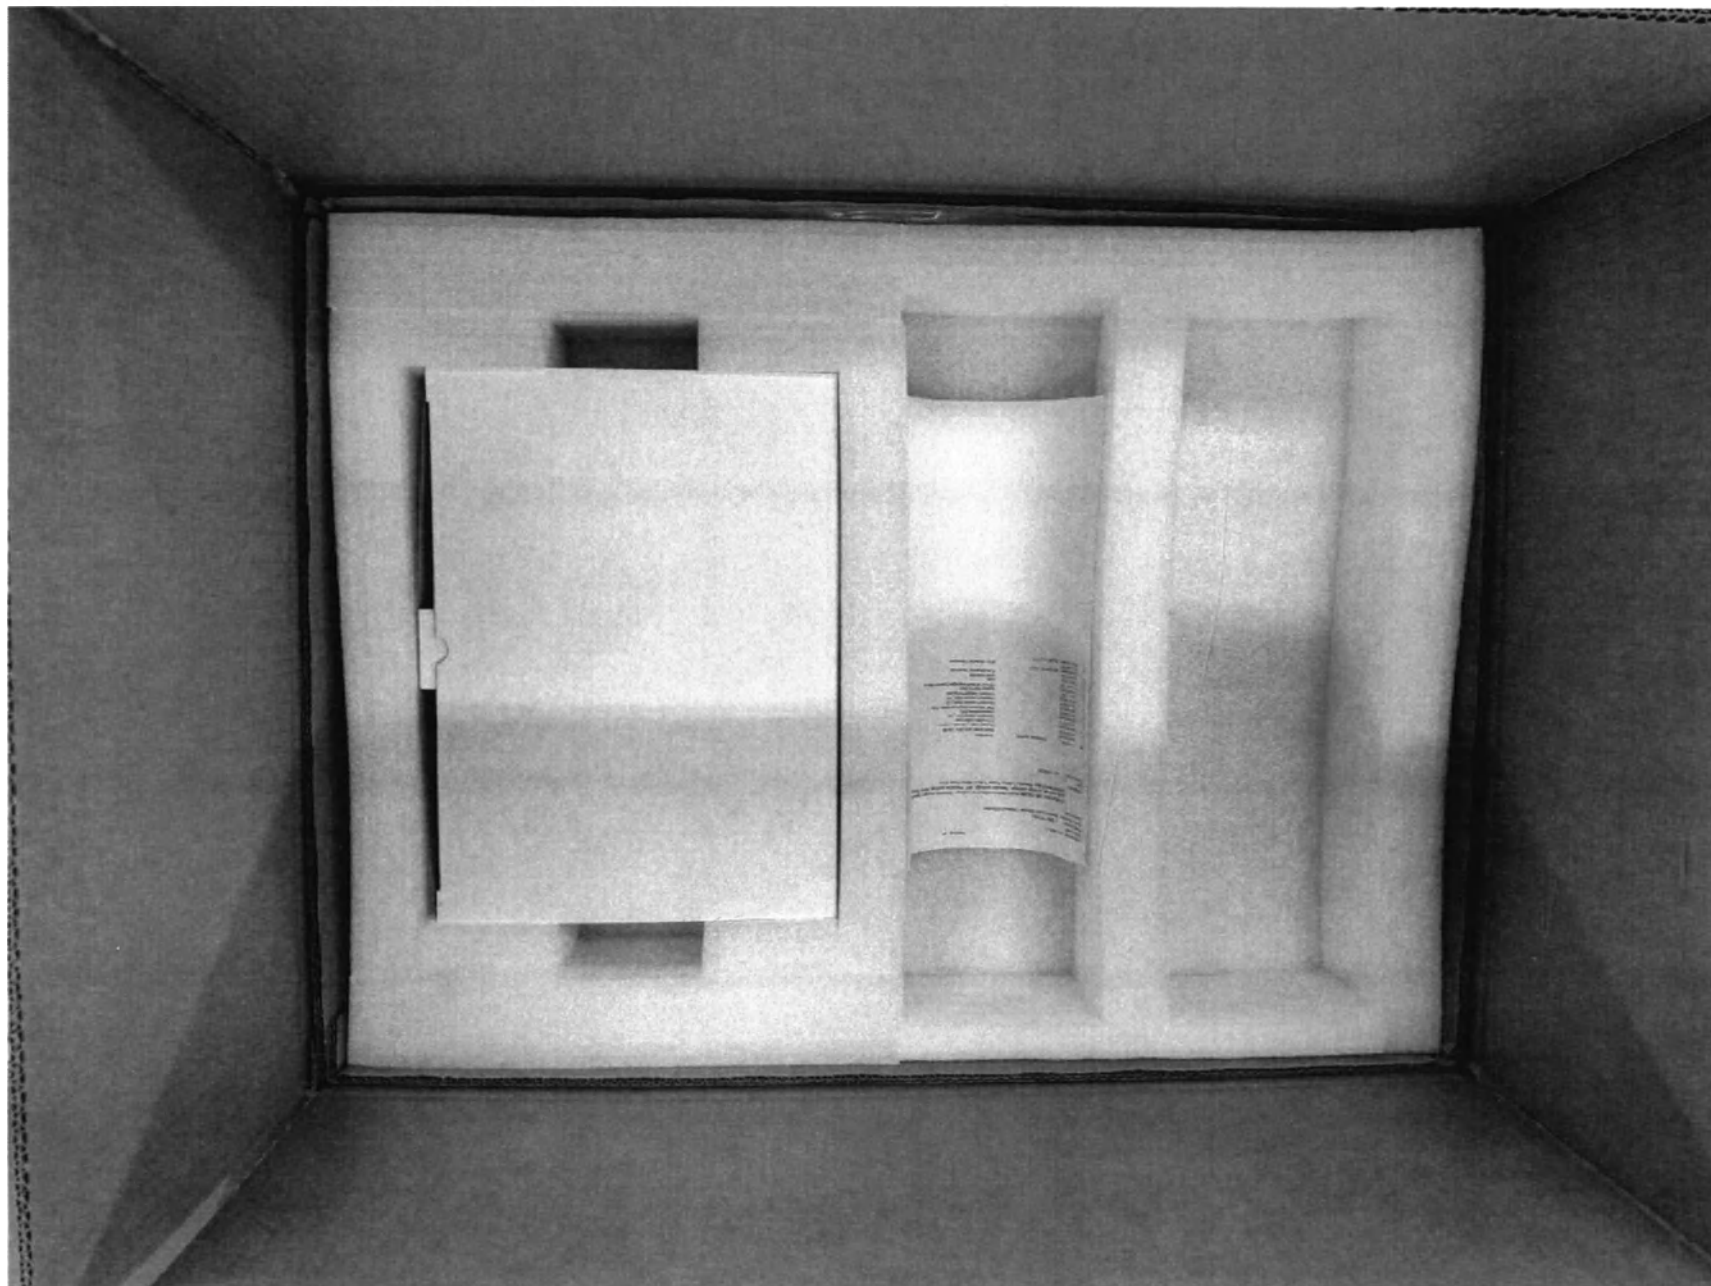

6 Картонная крышка транспортировочной коробки



Общий вид изделия в транспортной упаковке







двадцать листов

Прошито 20 листов

Генеральный директор

ООО "Миндрей Медикал Рус"

Сюн Вей

