

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контрольных материалов «BioPlex 2200 ToRC IgM Control Set» для качественного определения антител класса IgM к возбудителям ToRC-инфекций в сыворотке или плазме человека методом мультиплексной проточной иммунофлуоресценции на приборе BioPlex 2200 с принадлежностями

производства

Bio-Rad Laboratories, Inc., США. 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547, USA

BIO-RAD

REF 12000678

BioPlex 2200

ToRC IgM Control Set

CTRL

4 x 1.5 mL

A quality control for the
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.
Eine Qualitätskontrolle für den
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.
Un contrôle de qualité pour le
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.
Un controllo di qualità per il
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.
Un control de calidad para el
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.
Um controlo de qualidade para o
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

UNITED STATES: Bio-Rad Laboratories, Inc. Clinical Diagnostics Group,
4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547

FRANCE: Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré,
92430 Marnes-la-Coquette

BIO-RAD

REF 12000678

BioPlex 2200

ToRC IgM Control Set

CTRL

4 x 1.5 mL

En kvalitetskontroll for
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

En kvalitetskontroll til
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

Kontrolni material pro
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

En kvalitetskontroll for
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

Набор контрольных материалов для
BioPlex 2200 ToRC IgM.

Um controle de qualidade para o
BioPlex 2200 ToRC IgM Reagent Pack.

16001305 rev b



Rx Only



CE 0459



IVD



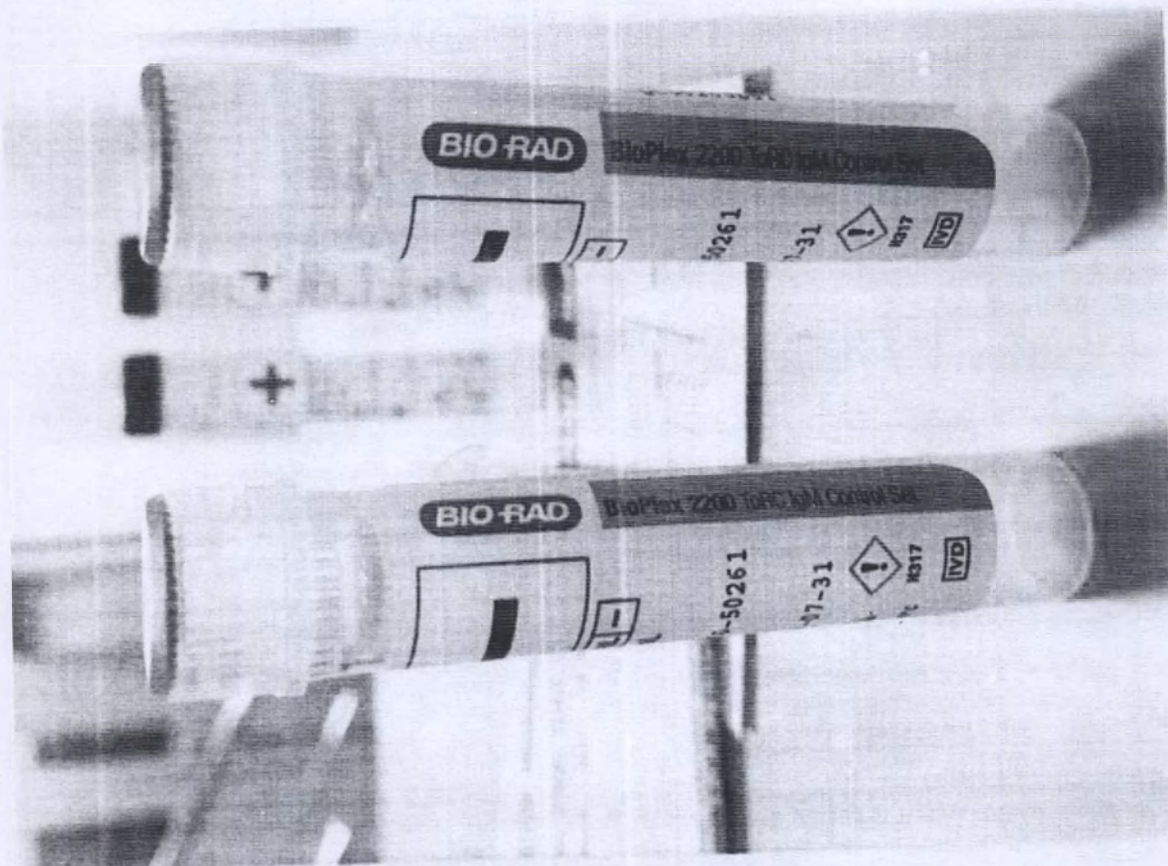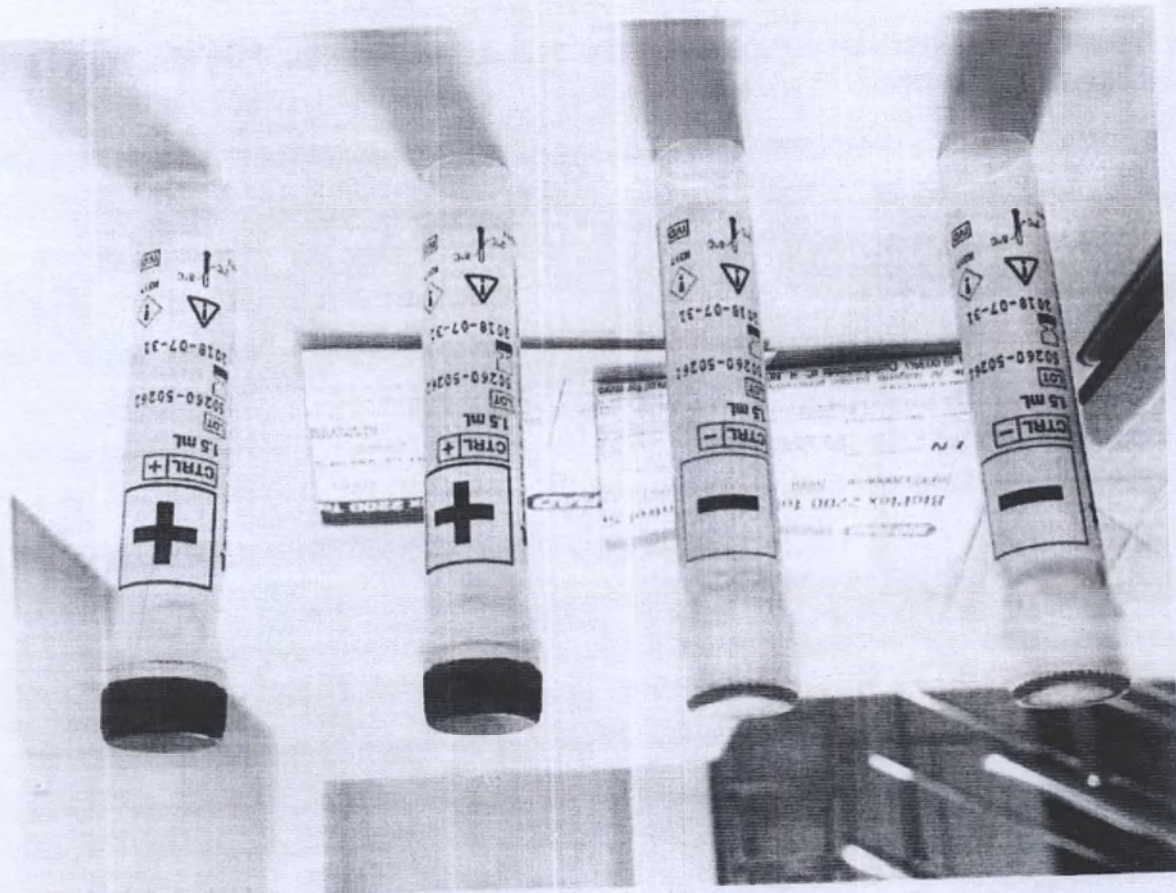

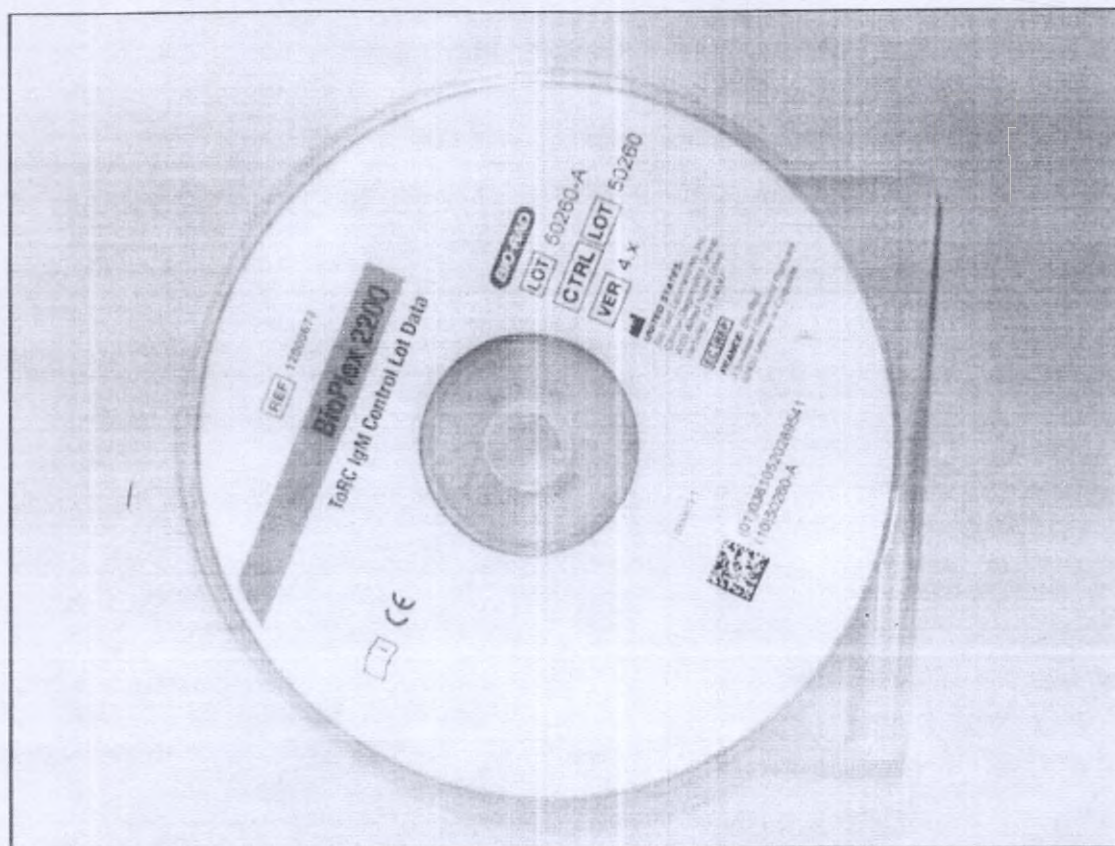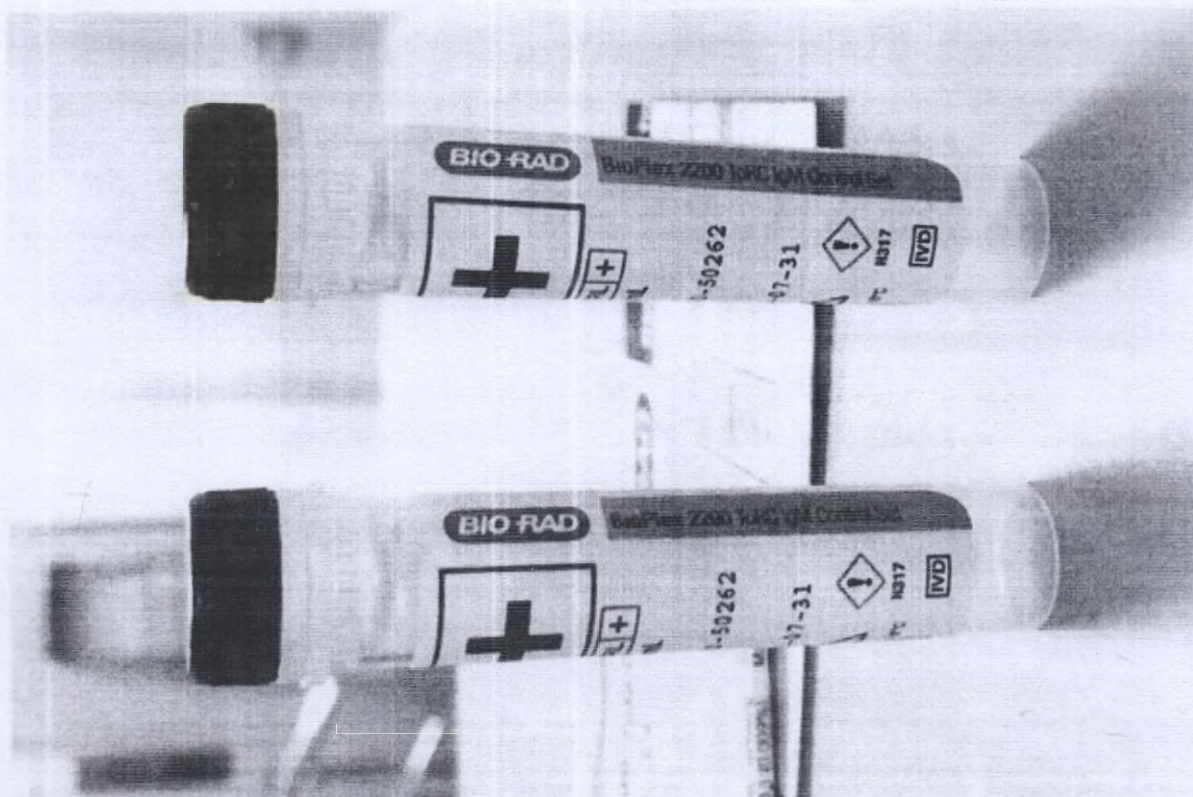

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 1 (матрица)