

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»




Покотилов М.Б.

20 24 г.

Фотографии медицинского изделия «Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп»,
48х6 тестов (Cellbind Direct Type, 48х6 tests)»

Производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam,
Нидерланды

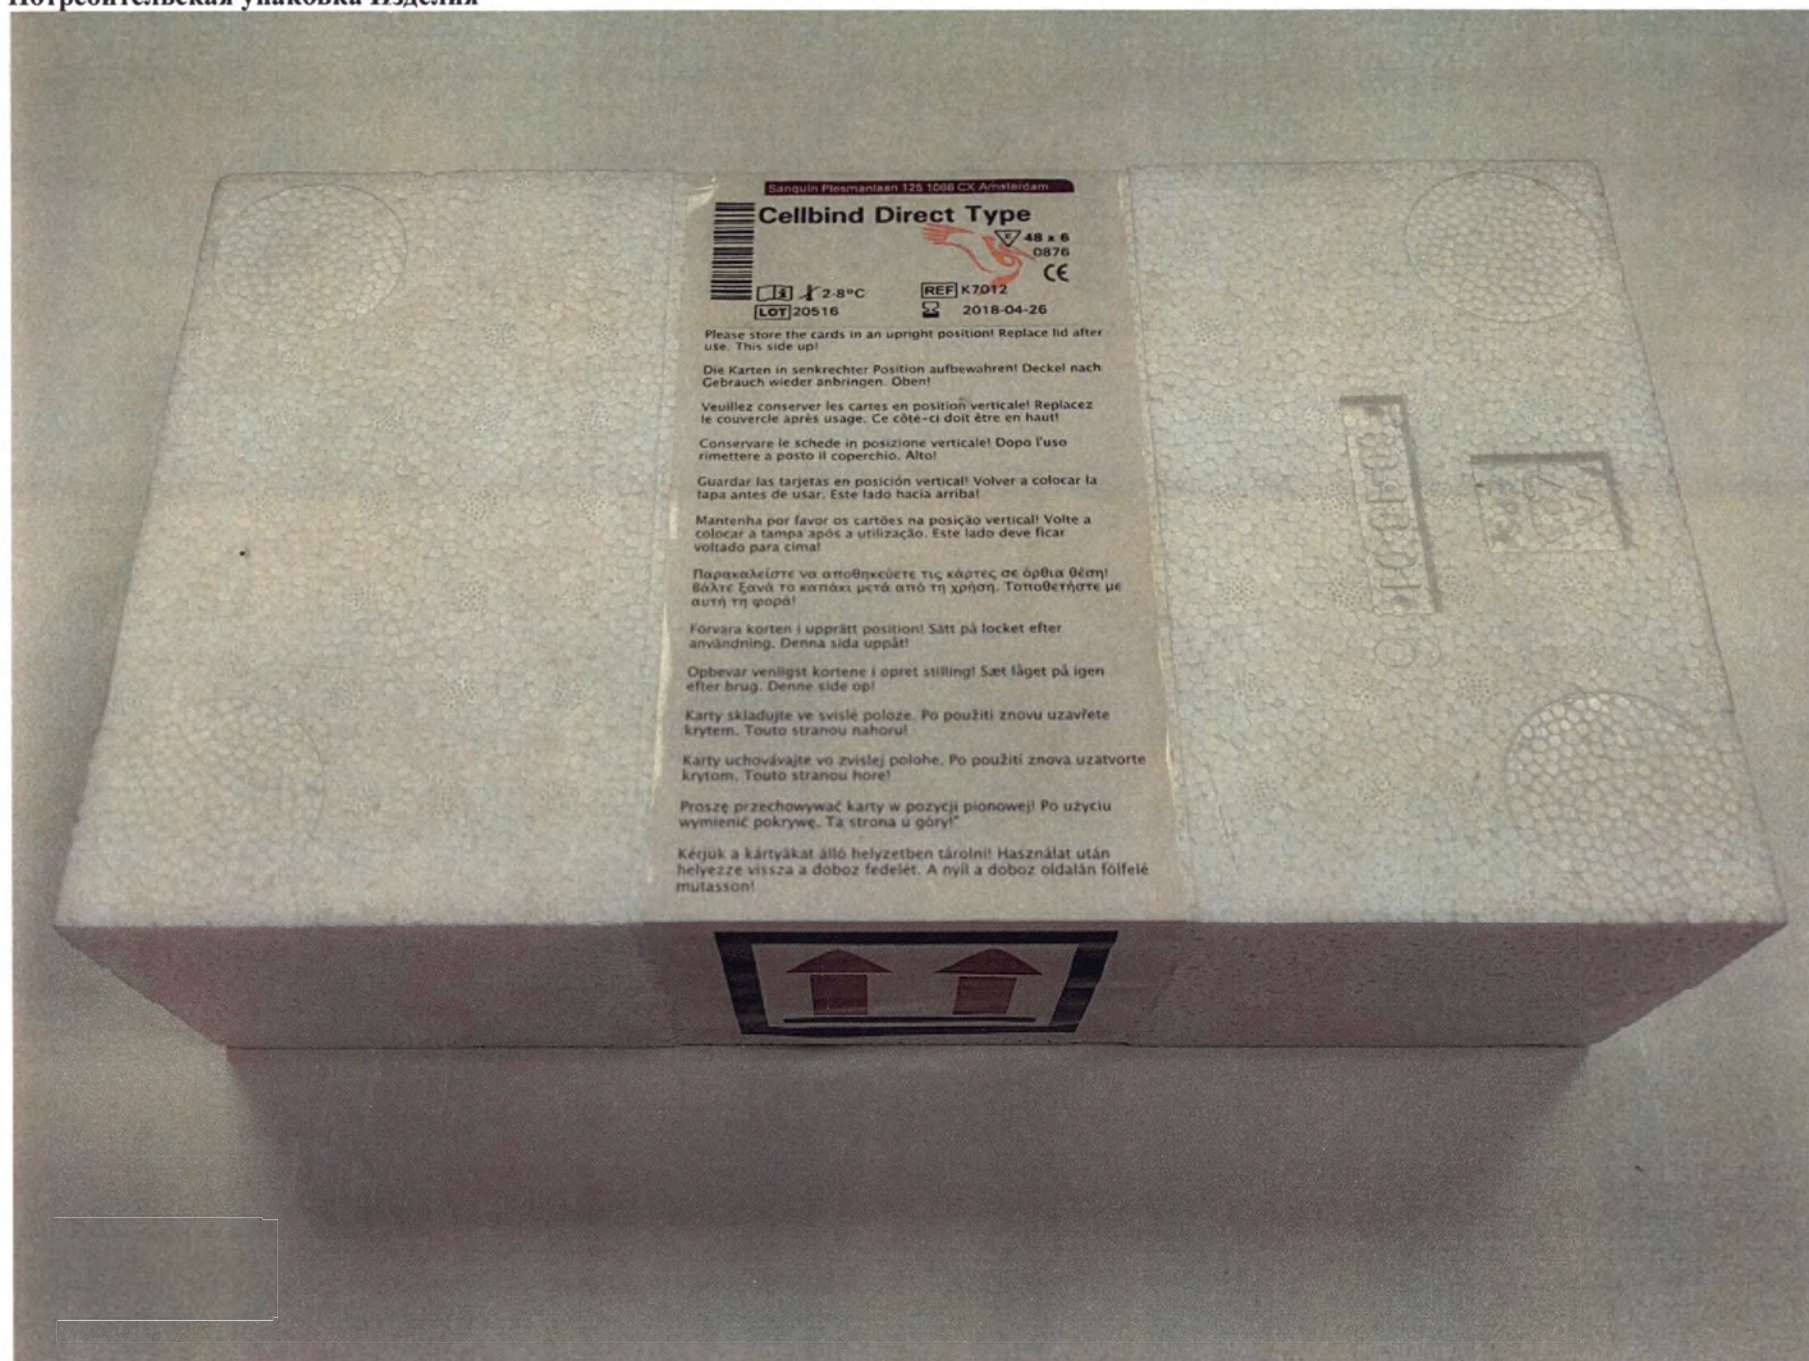

Sanguin Plesmanlaan 125 1086 CX Amsterdam

Cellbind Direct Type

48 x 6
0876
CE

2.8°C
LOT 20516
REF K7012
2018-04-26

Please store the cards in an upright position! Replace lid after use. This side up!

Die Karten in senkrechter Position aufbewahren! Deckel nach Gebrauch wieder anbringen. Oben!

Veillez conserver les cartes en position verticale! Remplacez le couvercle après usage. Ce côté-ci doit être en haut!

Conservare le schede in posizione verticale! Dopo l'uso rimettere a posto il coperchio. Alto!

Guardar las tarjetas en posición vertical! Volver a colocar la tapa antes de usar. Este lado hacia arriba!

Mantenha por favor os cartões na posição vertical! Volte a colocar a tampa após a utilização. Este lado deve ficar voltado para cima!

Παρακαλέστε να αποθηκεύετε τις κάρτες σε όρθια θέση! Βάλτε ξανά το καπάκι μετά από τη χρήση. Τοποθετήστε με αυτή τη φορά!

Förvara korten i upprätt position! Sätt på locket efter användning. Denna sida uppåt!

Opbevar venligst kortene i opret stilling! Sæt låget på igen efter brug. Denne side op!


Karty skladujte ve svislé poloze. Po použití znovu uzavřete krytem. Touto stranou nahoru!

Karty uchovávajte vo zvislej polohe. Po použití znova uzavorte krytom. Touto stranou hore!

Proszę przechowywać karty w pozycji pionowej! Po użyciu wymienić pokrywę. Ta strona u góry!

Kérjük a kártyákat álló helyzetben tárolni! Használat után helyezze vissza a doboz fedelét. A nyíl a doboz oldalán föléfelé mutat!

Содержимое потребительской упаковки Изделия

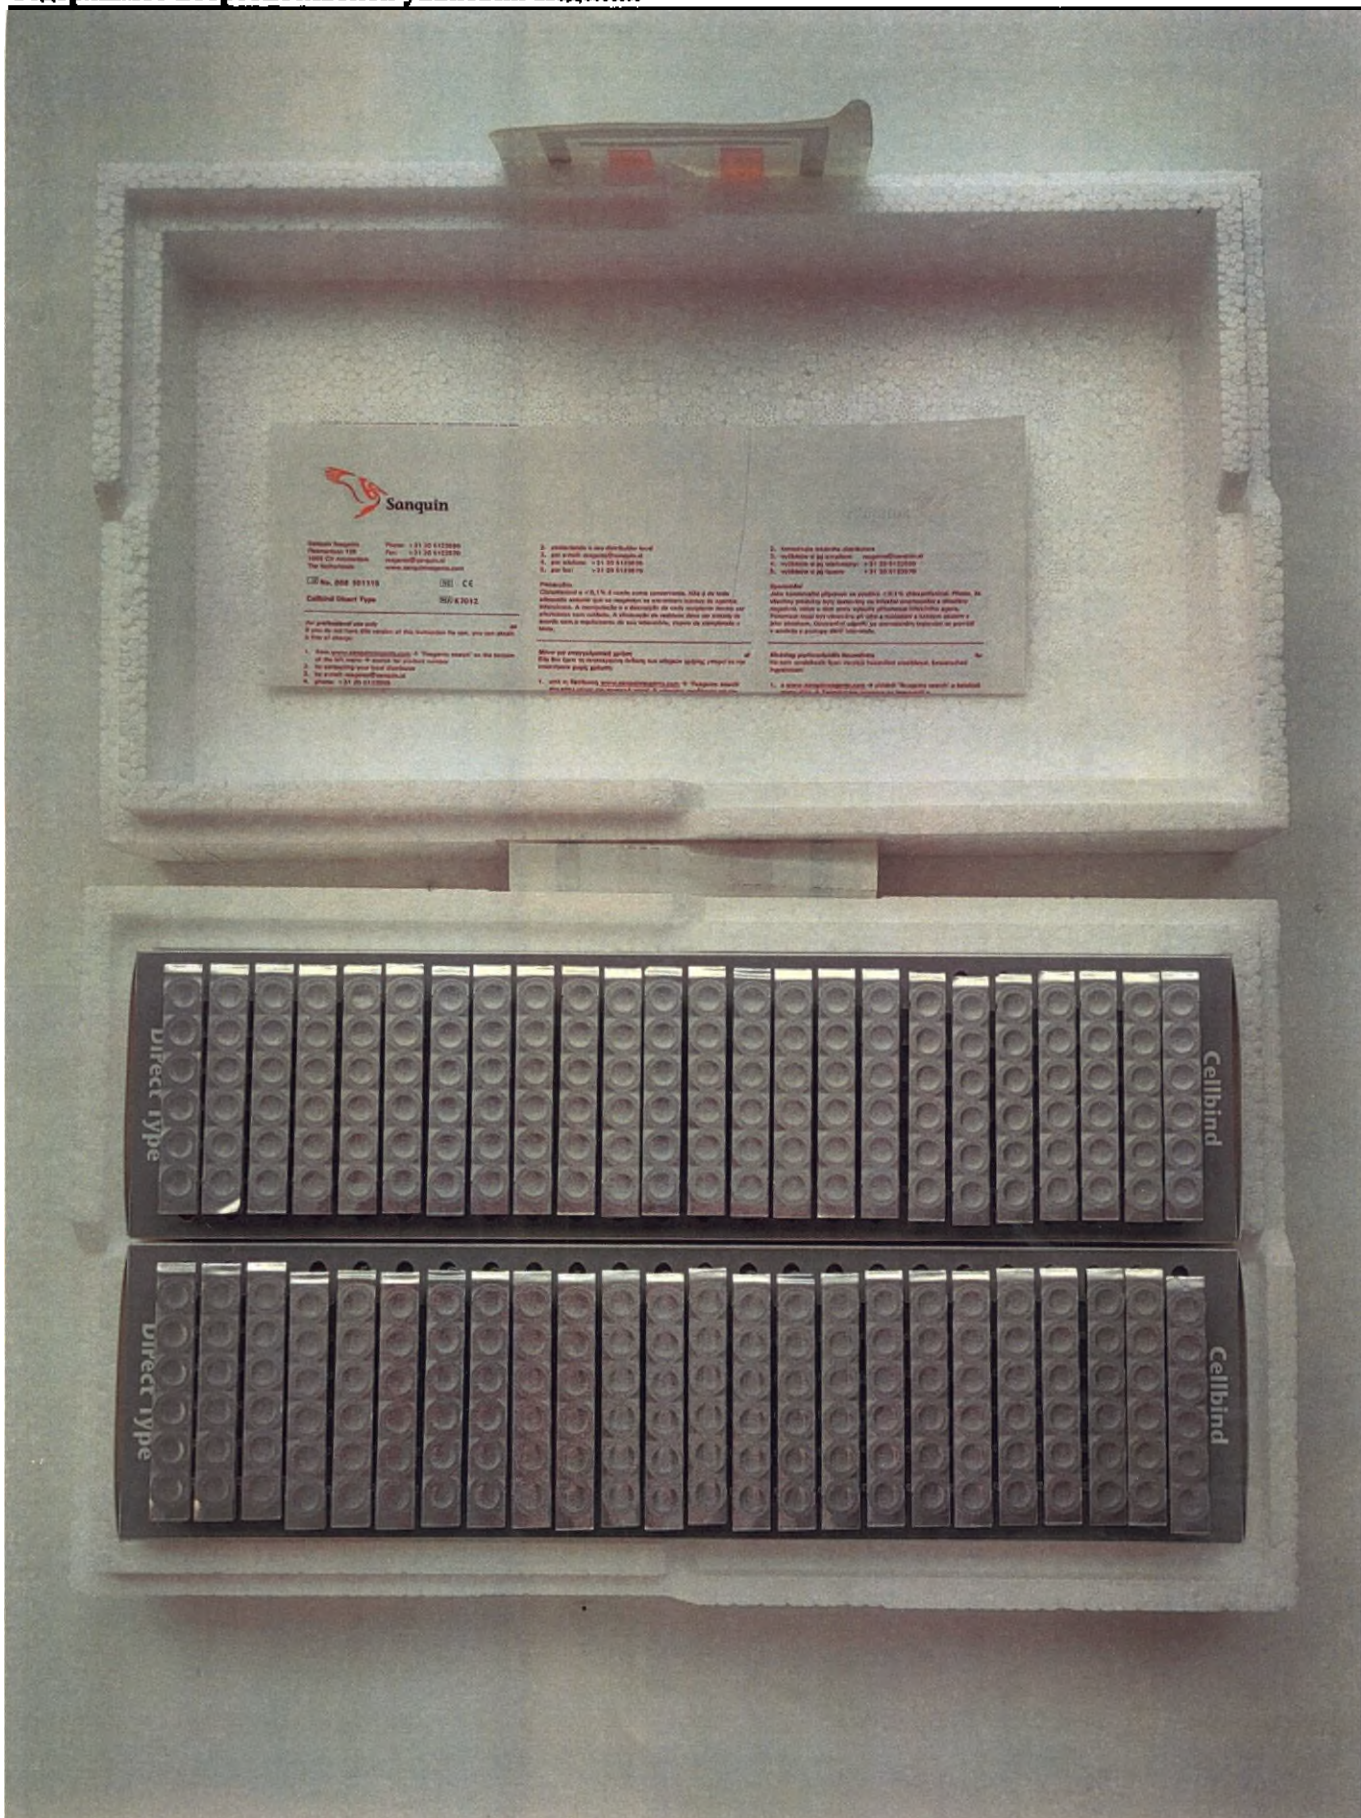





--	--	--	--	--	--

49573



LOT 20516

 2018-04-26

Прошито, пронумеровано

5 (пять) листов

Генеральный директор
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»

М.Б. Покотилев





ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»
Фактический адрес: 115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 10, стр.1, эт. 6
тел.: +7 (499) 579 3303
info@mirus-medical.com, www.mirus-medical.com



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»
Покотилов М.Б.

«02» июля 2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов (Cellbind Direct Type, 48х6 tests),

Производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерланды

Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов (Cellbind Direct Type, 48х6 tests)

Регистрационное
удостоверение:

Артикул K7012

Изготовитель: «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерланды

Место
производства
медицинского
изделия: Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерланды

Уполномоченный
представитель производителя
в РФ: ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, пом.2-8, 12-18, эт.06

Тел./факс: +7 499 579 33 03/02

e-mail: info@mirus-medical.com