



Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 - 1075 AC Amsterdam
telefoon: 020 - 5736311
fax: 020 - 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

file: PDM/2021.001046.01/cdw

Seen by me, Marloes Corine Koster, assigned civil-law notary in the protocol of Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, civil-law notary in Amsterdam, The Netherlands, for legalization of the signature written in the attached document of Mrs Anthonia Helena Louisa KOENDERMAN, born in Utrecht (The Netherlands) on the thirty-first day of October nineteen hundred and fifty-six, acting as proxy holder with special power of attorney of and in this matter duly representing the private limited company: Sanquin Reagents B.V., with statutory seat in Amsterdam, and with address at 1066 CX Amsterdam, The Netherlands, Plesmanlaan 125, registered at the Trade Register under number 67177565.

This above statement is not intended to give any legal opinion as to the contents and the validity of the original document.

Amsterdam, 16 February 2021.





Sanquin Reagents B.V.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов
(Cellbind Direct Type, 48х6 tests)

Производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125,
1066 CX Amsterdam, Нидерланды.

Номер версии	Дата утверждения	ФИО	Должность	Подпись
1	03.01.2019	Анки Кундерман / Anky Koenderman	Менеджер по вопросам государственной регистрации/ Regulatory Affairs Officer	 12 Febr 2021

2019 г.

Настоящая инструкция относится к медицинскому изделию для диагностики in vitro для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов (Cellbind Direct Type, tests)» (далее по тексту – «Изделие» или «Изделия» или «гелевые карты»).

Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие «Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов (Cellbind Direct Type, 48х6 tests)» предназначено для определения группы крови человека для всех типов образцов, включая образцы с положительным прямым антиглобулиновым тестом (DAT).

Изделие предназначено для использования только в автоматической системе «Анализатор автоматический для иммуногематологических исследований in vitro «Magister C24», производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.).

Условия применения:

Изделие следует использовать только в медицинских целях квалифицированным медицинским персоналом, прошедшим обучение для корректного использования Изделия. Изделие предназначено только для профессионального применения.

Потенциальные потребители: персонал лечебно-профилактических учреждений, имеющих в своем составе клинико-диагностические лаборатории, лаборатории in vitro диагностики, станции и отделения переливания крови.

Область применения: клиническая лабораторная диагностика, иммуногематология.

Показания к применению:

Изделие применяется для тестирования доноров крови и ее компонентов, реципиентов гемотрансфузий, а также женщин в рамках обследования в период беременности, родов и в послеродовом периоде.

Противопоказания к применению

Медицинских противопоказаний для применения Изделия нет.

Технические характеристики и состав медицинского изделия

Гелевые карты изготавливаются из полипропилена. Каждая карта включает 6 колонок, заполненных бесцветным гелевым наполнителем с добавлением буфера, содержащего антитела анти-IgM (моноклональные). Каждая гелевая карта рассчитана на 6 определений. Состав компонентов Изделия и фасовка указаны в Таблице 1.

Артикул	Название варианта исполнения	Наименование параметра	Значение параметра
K7012	Карта для определения групп крови «Селлбайнд Дайрект Тайп», 48х6 тестов (Cellbind Direct Type, 48х6 tests)	Фасовка	48 карт
		Кол-во тестов в 1 гелевой карте	6
		Материал изготовления гелевых карт	полипропилен
		Состав геля	Гелевый наполнитель, состоящий из сефарозы, суспензированной в ФСБ/БСА буфере. Каждая колонка гелевой карты содержит мышиные моноклональные антитела анти-IgM (клон 15-1), консервант хлорамфеникол <0,1%

Таблица 1. Фасовка и состав компонентов изделия.

Принципы метода исследования

В основе теста лежит реакция иммунофиксации (агглютинации) сенсibilизированных эритроцитов в гелевых картах. Клеточная суспензия эритроцитов пациента либо реагента эритроцитов добавляется в микроколону гелевой карты вместе с реагентами для определения группы крови либо плазмой крови пациента. Антиген-положительные эритроциты связываются

ответствующие антиэритроцитарные антитела, присутствующие в плазме или реагенте для определения группы крови, вызывая агглютинацию. Затем гелевые карты проходят три фазы центрифугирования. В первой фазе высокоплотная среда позволяет отделить эритроциты от плазмы или реагента. Во второй фазе агглютинированные сенсibilизированные эритроциты будут задерживаться на верху гелевого матрикса в колонке гелевой карты, а в третьей фазе несенсibilизированные или крайне слабо сенсibilизированные эритроциты будут двигаться ко дну колонки. После центрифугирования гелевые карты автоматически переносятся в считыватель, где происходит фотографирование колонок гелевой карты и считывание результата; затем результат анализирует управляющее программное обеспечение (далее – «ПО»):

- В случае наличия агглютинатов (комплексов «антиген-антитело» в виде слипшихся эритроцитов), в верхней части колонки на поверхности геля после центрифугирования наблюдается четкая красная полоса (положительный результат (4+)).
- В случае отсутствия агглютинатов на поверхности геля, на дне колонки наблюдается четкий красный осадок эритроцитов, продиффундировавших под действием центробежной силы сквозь толщу геля (отрицательный результат (-)).

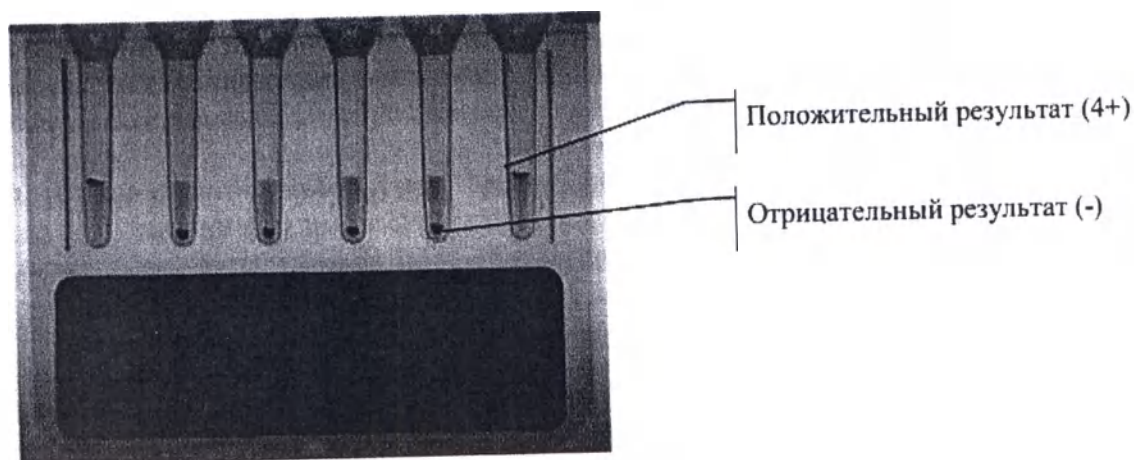


Рис. 1. Фотография результатов тестирования.

При наличии частичной агглютинации могут наблюдаться различные варианты: наличие двух четко выраженных полос различной интенсивности на поверхности геля и на дне микроколонки одновременно, либо наличие двух четко выраженных полос различной интенсивности на поверхности геля и на дне колонки вместе с частичным окрашиванием толщи геля. Оценка результата проводится в соответствии с встроенным алгоритмом ПО. В случае, если четкая интерпретация результата тестирования с помощью ПО невозможна, выводится соответствующее уведомление, оставляющее интерпретацию результатов на усмотрение врача. Более подробно интерпретация результатов описана в Разделе «Интерпретация результатов».

Для использования Изделия необходима соответствующая квалификация и полномочия медицинских работников. Неверный учет факторов интерференции, качества биологического материала могут привести к некорректной интерпретации результатов теста.

При исследованиях рекомендуется использовать отрицательный контроль и контрольные образцы с известными параметрами для исключения ложных результатов.

Предупреждения и меры предосторожности

Только для диагностики *in vitro*.

Каждая гелевая карта предназначена для однократного применения. Повторное использование гелевых карт недопустимо.

Запрещается использовать гелевые карты, содержащие воздушные пузырьки в гелевом матриксе, гелевые карты с поврежденной запечатывающей фольгой или гелевые карты с признаками высыхания (неравномерный уровень жидкости или отсутствие жидкости над гелевым матриксом).

После прочтения результатов гелевые карты можно закрыть и хранить в вертикальном положении при температуре 2-8°C в течение недели.

В изделиях потенциально могут содержаться инфекционные агенты. Соблюдать осторожность при использовании и утилизации каждой гелевой карты и ее содержимого.

Запрещается использовать гелевые карты (как распакованные, так и нераспакованные) после даты истечения срока годности, напечатанной на этикетке.

После проведения тестирования все отходы необходимо утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению медицинскими отходами».

Все манипуляции с гелевыми картами следует выполнять в защитных перчатках из нитрила.

Информация для подготовки медицинского изделия к безопасной работе и эксплуатации

Перед применением гелевые карты должны достичь температуры помещения. Для этого их необходимо выдержать на лабораторном столе в течение не менее 30 минут. По достижении комнатной температуры все компоненты изделия следует визуально оценить на предмет целостности, наличия следов протекания, загрязнения, бактериального роста. Запрещается использовать гелевые карты, содержащие воздушные пузырьки в гелевом матриксе, карты с поврежденной запечатывающей фольгой или с признаками высыхания (неравномерный уровень жидкости или отсутствие жидкости над гелевым матриксом). Компоненты изделия, имеющие указанные повреждения, применению не подлежат.

Все манипуляции с изделием и проведение тестирования проводятся в лабораторных помещениях с контролируемыми нормальными климатическими условиями.

Условия окружающей среды:

- температура окружающего воздуха +15 - 30°C;
- относительная влажность – 10 - 85% при 30°C или ниже;
- атмосферное давление – 760 ± 30 мм рт. ст.

Анализатор автоматический для иммуногематологических исследований *in vitro* «Magister C24» должен быть подготовлен к работе с Изделиями в соответствии с руководством пользователя.

Анализируемые образцы

Для проведения тестирования используется плазма и/или эритроциты крови пациента. Для выполнения исследования взятый образец цельной крови центрифугируют в течение 5 минут при 3000 gcf. Следует использовать кровь, взятую у обследуемого пациента не более, чем за 48 часов до проведения исследования. В случае, если тестирование образцов не производится незамедлительно после забора крови, следует хранить образцы при температуре 2 – 8°C до 48 часов. В случае тестирования плазмы после размораживания, ее необходимо центрифугировать в течение 5 минут при 3000 gcf для удаления преципитата.

Забор образцов крови надлежит производить в асептических условиях. В качестве гемоконсерванта предпочтительно использовать цитрат натрия, ЭДТА или гепарин.

Методика контроля

В зависимости от проводимых исследований методики контроля см. в инструкции на конкретный реагент.

При исследованиях рекомендуется использовать отрицательный контроль и контрольные образцы с известными параметрами для исключения ложных результатов.

Необходимые, но не поставляемые в комплекте реагенты, принадлежности и оборудование:

Тип реагентов/ расходных материалов	Артикул	Наименование
Моноклональные реагенты и стандартные эритроциты для	K1188	Реагент для определения антигена А эритроцитов человека «Пеликлон анти-А (IgM)

определения группы крови по системе АВО прямой и обратной реакцией		моноклональный», 3x10 мл (Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal, 3x10ml).
	K1189	Реагент для определения антигена В эритроцитов человека «Пеликлон анти-В (IgM) моноклональный», 3x10 мл (Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal, 3x10ml).
	K1190	Реагент для определения антигенов А, В эритроцитов человека «Пеликлон анти-А, В (IgM) моноклональный», 3x10 мл (Pelikloon anti A,B (IgM) monoclonal, 3x10ml).
	K7240	Реагент «Эритроциты А1 Селлбайнд» (Cellbind A1 reagent red cells).
	K7242	Реагент «Эритроциты В Селлбайнд» (Cellbind B reagent red cells).
Моноклональные реагенты для определения антигенов групп крови систем Rh и Келл	K1255	Реагент для определения антигена D эритроцитов человека «Пеликлон анти-D (IgM) моноклональный», 10 мл (Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal 10 ml).
	K1151	Реагент для определения антигена D эритроцитов человека «Пеликлон анти-D усиленный (IgM) моноклональный», 10 мл (Pelikloon Anti-D enhanced (IgM) monoclonal, 10 ml);
	K1191	Реагент для определения антигена Е эритроцитов человека «Пеликлон анти-Е (IgM) моноклональный», 5 мл (Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal, 5ml).
	K1195	Реагент для определения антигена С эритроцитов человека «Пеликлон анти-С (IgM) моноклональный», 5 мл (Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal, 5ml).
	K1196	Реагент для определения антигена С эритроцитов человека «Пеликлон анти-с (IgM) моноклональный», 5 мл (Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal, 5ml).
	K1197	Реагент для определения антигена е эритроцитов человека «Пеликлон анти-е (IgM) моноклональный», 5 мл (Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal, 5ml).
	K1199	Реагент для определения антигена К (Келл) эритроцитов человека «Пеликлон анти-К (IgM) моноклональный», 5 мл (Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal, 5ml).
Стандартные эритроциты для иммуногематологических исследований	K7243	Реагент «Эритроциты О+ Селлбайнд» (Cellbind O positive reagent red cells).
Контрольные материалы	K1379	Контрольный материал для иммуногематологических исследований «Пеликонтроль», 2x8 мл (Pelicontrol, 2x8ml).
	K1399	Контрольный материал для иммуногематологических исследований «Пеликонтроль СсЕе-К», 8 мл (PeliControl CcEe-K; 8 ml)
	K1156	Контрольный реагент для определения групп крови человека «Пеликлон контроль моноклональный», 10 мл (Pelikloon Control monoclonal, 10ml)
Раствор слабой ионной силы (ЛИСС)	K7130	Раствор низкой ионной силы «Селлбайнд ЛИСС», 3x25 мл (Cellbind LISS, 3 x 25 ml)

Оборудование	K7320	Анализатор автоматический для иммуногематологических исследований in vitro «Magister C24»
Принадлежности/аксессуары	K7390	Шарики для перемешивания
		Пробирки для предварительного разведения объемом 1.3 мл с круглым дном (например, производства Greiner Bio-one)

Порядок выполнения тестирования


Процедуры тестирования

1. Подождать, пока реагенты и гелевые карты достигнут комнатной температуры (18-25°C).
2. Не используйте гелевые карты, в которых обнаружены воздушные пузыри в гелевом матриксе, поврежденная фольга или признаки высыхания (неравномерный уровень жидкости или отсутствие жидкости над гелевым матриксом).
3. Распаковать и установить в соответствующие отсеки анализатора автоматического для иммуногематологических исследований in vitro «Magister C24» гелевые карты, раствор низкой ионной силы «Селлбайнд ЛИСС», 3x25 мл (Cellbind LISS, 3 x 25 ml) (далее – раствор ЛИСС), требуемые реагенты и стандартные эритроциты для определения группы крови, согласно назначениям для тестируемых образцов, пробирки для предварительного разведения и соответствующие контрольные материалы в зависимости от протокола тестирования.
4. Анализатор выводит на экран доступные количества расходных материалов, оставшихся после предыдущего сеанса, в соответствующем разделе программы.
5. В штатив для образцов установить пробирки с образцами крови, предназначенными для исследования. Данные проб будут идентифицированы анализатором автоматически при помощи штрих-кода, либо можно внести данные об образцах вручную.
6. При помощи программного обеспечения анализатора автоматического для иммуногематологических исследований in vitro «Magister C24» задать необходимый для образцов крови перечень исследований.
7. Анализатор автоматически выберет реагенты, необходимые для проведения заданных исследований.
8. Перед внесением в гелевую карту эритроциты образца при помощи наконечников анализатора забираются со дна пробирки и раскапываются в пробирки для предварительного разведения, где смешиваются с раствором ЛИСС для разведения до нужной концентрации, уменьшения ионной силы взаимодействия между эритроцитами, усиления чувствительности и подавления неспецифических реакций при проведении иммуногематологических исследований с помощью гелевых карт, что значительно улучшает связывание эритроцитов в ходе реакции агглютинации.
9. После разведения подготовленная суспензия эритроцитов или плазма образца при помощи наконечника для раскапывания вносится в колонку гелевой карты. Далее, согласно программе исследования, анализатор вносит в колонку гелевой карты необходимое количество соответствующих реагентов.
10. После этого проводится центрифугирование гелевых карт.
11. По завершении центрифугирования гелевые карты фотографируются встроенной фотокамерой, и изображение передается в ПО анализатора для интерпретации и оценки результатов теста. Результаты теста признаются валидными только при их соответствии результатам тестирования соответствующих контрольных материалов.
12. Программное обеспечение Анализатора автоматического для иммуногематологических исследований in vitro «Magister C24» интерпретирует реакцию автоматически. Фотографические изображения гелевых карт выводятся на экран. Авторизованный пользователь может валидировать результаты теста или скорректировать их. При изменении результатов теста фиксируется дата и время внесения изменения, а также данные оператора, внесшего изменение.

13. После проведения исследования гелевые карты, реагенты и контрольные материалы необходимо извлечь из анализатора и убрать на хранение в холодильник до следующего исследования. Температурный режим хранения 2-8°C.
14. После проведения тестирования все отходы необходимо утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
15. На следующий день перед началом работы реагенты, контрольные материалы и гелевые карты следует извлечь из холодильника и выдержать перед установкой в анализатор при комнатной температуре.

Интерпретация результатов

В случае положительных реакций эритроциты улавливаются и остаются в верхнем слое гелевого матрикса в виде полосы. В случае отрицательных реакций эритроциты оказываются на дне микроколоники. Результаты реакции показаны на рисунке:

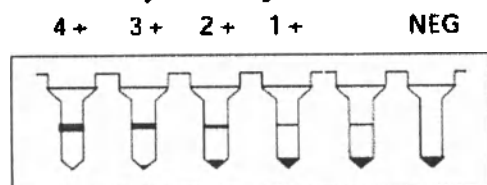

Количество эритроцитов, захваченных в верхнем слое гелевого матрикса, будет зависеть от таких параметров, как антигенная плотность эритроцитов и титры и аффинность антител. Оно также определяется продолжительностью второй фазы центрифугирования и центробежной силой во время третьей фазы.

Следовательно, если реакция слабее, чем 4+, клетки также появятся на дне микроколоники. Тот же рисунок будет наблюдаться при реакциях смешанного типа.

Определение группы крови

Положительные реакции с реагентами для определения группы крови указывают на наличие соответствующих антигенов на эритроцитах крови обследуемого. Отрицательные реакции с реагентами для определения группы крови указывают на то, что наличие соответствующих антигенов на эритроцитах определить нельзя.

Определение группы крови обратной реакцией

Положительные реакции означают присутствие соответствующих аллоантител в плазме крови обследуемого. Отрицательные реакции означают отсутствие соответствующих аллоантител в плазме крови обследуемого.

Ограничения методики исследования

Ложноположительные результаты могут быть получены по следующим причинам: псевдоагглютинация, аутоагглютинация, реакции смешанного типа, присутствие определенных медицинских препаратов в образце, слишком высокая концентрация тестируемых эритроцитов, покрытие эритроцитов пациента *in vivo* IgM или IgA антителами, наличие в образце аллоантител, отличных от анти-А и анти-В.

Ложноотрицательные или слабые результаты могут быть получены по следующим причинам: реакции смешанного типа, химеризм, пониженная активность реагентов, недостаточное взаимодействие суспензии эритроцитов с плазмой или реагентом в инкубационном отсеке микроколоники гелевой карты или преждевременное взаимодействие содержимого инкубационного отсека микроколоники с высокоплотной средой. Также ложноотрицательные или слабые результаты могут быть получены в случае, если для исследования используется плазма крови новорожденного, очень пожилого человека или пациента с гипогаммаглобулинемией.

Ложноположительные или ложноотрицательные результаты могут быть получены из-за присутствия воздушных пузырьков в гелевом матриксе карты, загрязнения тестовых материалов

или отклонения от рекомендуемых методов. При тестировании гемолизированных образцов возникнуть неспецифические реакции.

Если образец содержит остатки фибрина, это может привести к задержке несенсибилизированных клеток во время центрифугирования, в результате чего в верхней гелевой матрикса появится тонкая красная линия.

Диагностические функциональные характеристики

Для типизирующих реагентов были получены обследованные образцы из Национального банка крови в Нидерландах, которые были проверены при рутинном тестировании крови доноров.

Для обнаружения антител были использованы отрицательные образцы из лаборатории пренатального скрининга Sanquin. Для известных антител были получены замороженные образцы из референсной лаборатории, которые были исследованы в технологии пробирочного теста. Результаты получены из архивов референсной лаборатории.

Каждый образец единожды тестировался и сравнивался с референсным методом.

Результаты определения чувствительности и специфичности иммуногематологических тестов, проводимых с помощью Изделия с использованием реагентов диагностических производства «Санквин Реагенты Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.) представлены в Таблице 2:

Арт.	Описание	Специфичность	Чувствительность
K1188	Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal	100%	100%
K1189	Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal	100%	100%
K1190	Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal	100%	100%
K1255	Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal	100%	100%
K1156	Pelikloon control monoclonal	100%	100%
K1151	Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal	100%	100%
K1195	Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal	100%	100%
K1196	Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal	100%	100%
K1191	Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal	100%	100%
K1197	Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal	100%	100%
K1199	Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal	100%	100%
K7240	Cellbind A ₁ reagent red cells	100%	100%
K7242	Cellbind B reagent red cells	100%	100%
K7243	Cellbind O positive reagent red cells	100%	100%

Таблица 2. Результаты определения чувствительности и специфичности.

Воспроизводимость составила 100%

Информация о характеристиках стабильности медицинского изделия

Срок годности:

Общий срок годности Изделия с даты производства составляет 21 месяц при хранении при температуре 2-8°C. При соблюдении условий хранения и транспортировки Изделие сохраняет стабильность до истечения срока годности.

Условия хранения:

Изделие следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2°C до 8°C до истечения срока годности товара. Хранение Изделия при температуре от 2°C до 8°C должно осуществляться в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим с ежедневной регистрацией температуры. Допускается хранение при комнатной температуре (18-25°C) после транспортировки в не вскрытой упаковке в течение не более 3 месяцев. Замораживание не допускается.

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

После первого вскрытия упаковки Изделия все его компоненты стабильны до истечения срока годности, указанного на его упаковке. Вскрытые изделия следует хранить при температуре от

до 8 °С в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим с ежедневной регистрацией температуры.

Невскрытые и вскрытые Изделия по окончании срока годности использованию не подлежат.

Невскрытые и вскрытые Изделия по окончании срока годности следует утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Условия транспортировки:

Транспортировка Изделия требует соблюдения «холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима от 2 до 8 °С, в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой, или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов. Замораживание не допускается.

Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Содержание лекарственных средств для медицинского применения

Изделие не содержит лекарственных средств для медицинского применения.

Содержание материалов животного и (или) человеческого происхождения

В состав изделия входят мышинные моноклональные антитела анти-IgM антитела. Все лабораторные животные, материалы которых используются для производства антител, содержатся в надлежащих условиях в полном соответствии с инструкциями ЕЭС по содержанию лабораторных животных. Кроме того, все отбираемые животные проходят регулярные осмотры по проверке состояния здоровья и на наличие инфекционных заболеваний.

Информация о стерильном состоянии медицинского изделия

Изделие не является стерильным и не подлежит стерилизации перед применением.

Информация о природе, типе, а также об интенсивности и распределении излучения медицинского изделия

Изделие не является источником каких-либо излучений.

Биологический референтный интервал

Понятие биологического референтного интервала не применимо к Изделию, поскольку Изделие предназначено для качественного определения аналитов.

Предупреждения и меры предосторожности, предпринимаемые при утилизации медицинского изделия

Все работы с использованием Изделия и его компонентов необходимо проводить в защитных перчатках из нитрила.

После проведения тестирования все отходы необходимо утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Не пригодные к использованию Изделия и их компоненты необходимо утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Гарантии производителя

Производитель гарантирует, что при соблюдении правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации Изделие соответствует всем заявленным характеристикам.

Производитель не несет ответственности за возможные последствия вследствие применения изделия не по назначению.

Организация, осуществляющая прием, учет и рассмотрение рекламаций по качеству товара: ООО «МИРУС МЕДИКАЛ». Адрес для отправки рекламаций по качеству товара: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, пом.2-8, 12-18, эт.06. Тел.: (499) 579 3303. E-mail: info@mirus-medical.com.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)

Уполномоченным представителем производителя (изготовителя) Изделия является ООО «МИРУС МЕДИКАЛ». Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, пом.2-8, 12-18, эт.06. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, пом.2-8, 12-18, эт.06. Тел.: (499) 579 3303, e-mail: info@mirus-medical.com.

Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

Annex I of the Directive 98/79/EC, ISO 13485, ISO 14971, ISO 118113-1, ISO 118113-2, ISO 15223-1, ISO 23640, DIN EN 13641, DIN EN 13612.

/Гербовая печать: /

КОРОЛЕВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Любберс эн Дейк нотарииссен
Аллея Короля, 4 – 1075 AC Амстердам
телефон: 020 – 5736311
факс: 020 – 6799828
эл. адрес: mail@lubbers.nl

Документ: PDM/2021.001046.01/cdw

Я, Марлос Корин Костер, назначенный нотариус в протоколе Петруса Леопольдуса Элизы Мауриса де Мейера, нотариуса в г. Амстердаме, Нидерланды, настоящим удостоверяю подлинность подписи, поставленной на прилагаемом документе Г-жи Антонии Хелены Луизы КУНДЕРМАН, родившейся в г. Утрехте (Нидерланды) тридцать первого октября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, действующей в качестве доверенного лица со специальной доверенностью и по данному вопросу представляющей частную компанию с ограниченной ответственностью: Санквин Реагентс Б.В., имеющую юридический адрес в г. Амстердаме, находящуюся по адресу 1066 CX Амстердам, Нидерланды, аллея Плесмана, 125, зарегистрированную в Торговом реестре под номером 67177565.
Заявление выше не имеет своей целью дать юридическое заключение как в отношении содержания, так и в отношении действительности оригинального документа.

г. Амстердам, 16 февраля 2021 г.

/подписано/

/Тисненая печать: /

Г-жа М.К. КОСТЕР, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОТАРИУС
Г-н П.Л.Э.М. де МЕЙЕР, НОТАРИУС В Г. АМСТЕРДАМЕ

Перевод данного текста выполнен переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать девятого марта две тысячи двадцать первого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую, что
подписи переводчика Чимпоеш Елены Анатольевны.
Подпись сделана в моём присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021- 22-1012

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Г.Б. Акимов

Всего пронумеровано пронумеровано
и скреплено печатью листа (ов)
Нотариус:

Российская Федерация
Город Москва

24

мая две тысячи двадцать первого года

Я, Якушенко Евгения Александровна, нотариус
города Москвы, свидетельствую верность копии
с представленного документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/721-н/77-2021

Уплачено за совершение
нотариального действия

5 10182
780 руб

Б.А. Якушенко



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 лист
Нотариус