

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»




Докотиллов М.Б.

20 24 г.

Фотографии медицинского изделия «Карта для определения групп крови «Селлбайнд Скрин», 48x6 тестов (Cellbind Screen, 48x6 tests)»

Производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерланды

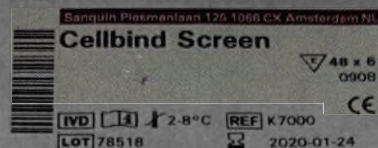

(en) Please store the cards in an upright position! Replace lid after use. This side up!

(bg) Моля, съхранявайте картите в изправено положение! Заменете капак след употреба. Тази страна нагоре!

(cs) Karty ukládajte ve svislé poloze. Po použití znovu uzavřete krytem. Touto stranou nahoru!

(da) Opbevar venligst kortene i opret stilling! Sæt låget på igen efter brug. Denne side op!

(de) Die Karten in senkrechter Position aufbewahren! Deckel nach Gebrauch wieder anbringen. Oben!

(el) Παρακαλείσθε να αποθηκεύετε τις κάρτες σε όρθια θέση! Βάλτε ξανά το καπάκι μετά από τη χρήση. Τοποθετήστε με αυτή τη φορά!

(es) Guardar las tarjetas en posición vertical! Volver a colocar la tapa antes de usar. Este lado hacia arriba!

(fr) Veuillez conserver les cartes en position verticale! Remplacez le couvercle après usage. Ce côté-ci doit être en haut!

(hu) Kérjük a kártyákat álló helyzetben tárolni! Használat után helyezze vissza a doboz fedelét. A nyíl a doboz oldalán fölfelé mutatson!

(it) Conservare le schede in posizione verticale! Dopo l'uso rimettere a posto il coperchio. Alto!

(lv) Lūdzu, uzglabāiet kārtis vertikālā stāvoklī. Pēc lietošanas, nomainiet vāciņu. Šī puse augšup!

(no) Vennligst oppbevar kortene i stående stilling! Sett på lokket etter bruk. Denne siden opp!

(pl) Proszę przechowywać karty w pozycji pionowej! Po użyciu wymienić pokrywę. Ta strona u góry!

(pt) Mantenha por favor os cartões na posição vertical! Volte a colocar a tampa após a utilização. Este lado deve ficar voltado para cima!

(ro) Păstrați cardurile în poziție verticală! Puneți capacul la loc după utilizare. Cu partea aceasta în sus!


(sk) Karty uchovávať vo zvislej polohe. Po použití znova zatvorte krytom. Touto stranou hore!


(sr) Čuvajte kartice u uspravnom položaju! Vratite poklopac nakon upotrebe. Ova strana treba da bude okrenuta prema gore!

(sv) Förvara korten i upprätt position! Sätt på locket efter användning. Denna sida uppåt!

(tr) Lütfen kartları dik şekilde saklayın! Kullanımdan sonra kapakını tekrar kapatın. Bu taraf yukarı gelecek!



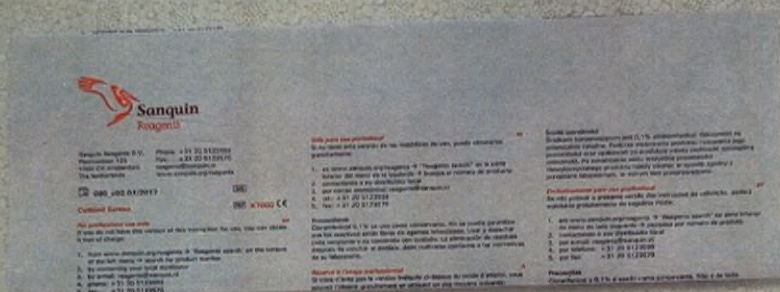


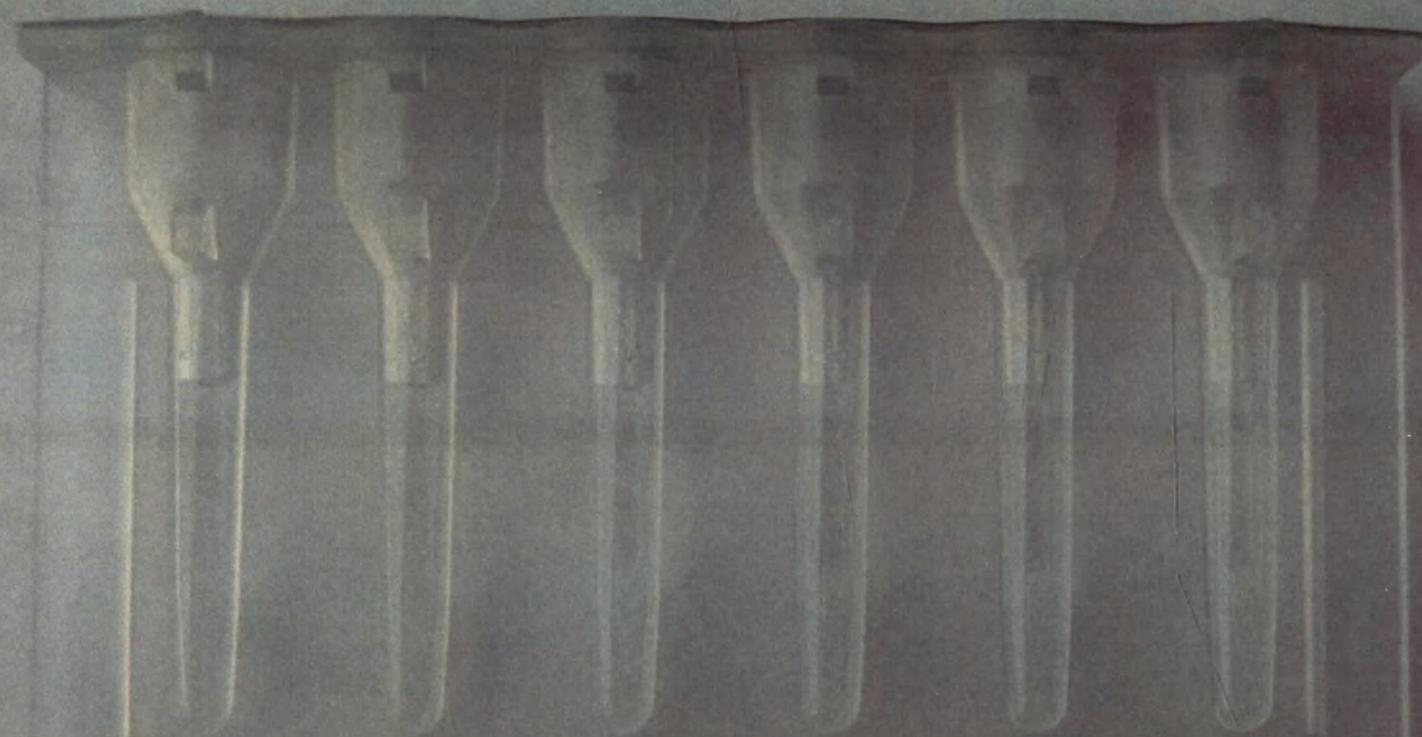


Sanquin Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam NL

Cellbind Screen



IVD



2-8°C



REF

K7000



6



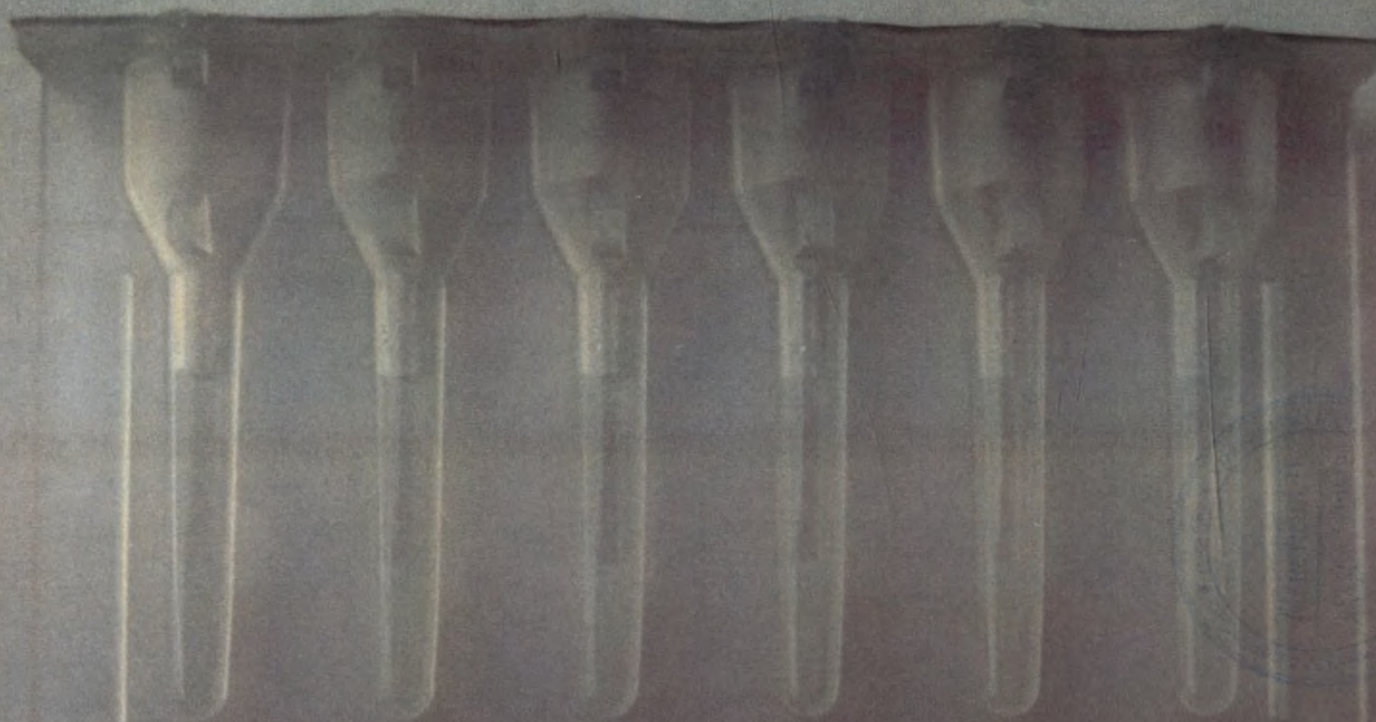

54240

LOT

78518



2020-01-24



Прошито, пронумеровано

5 (*пять*) листов

Генеральный директор
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»

М.Б. Покотилов

