

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
«13» мая 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM
CKMB CAL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

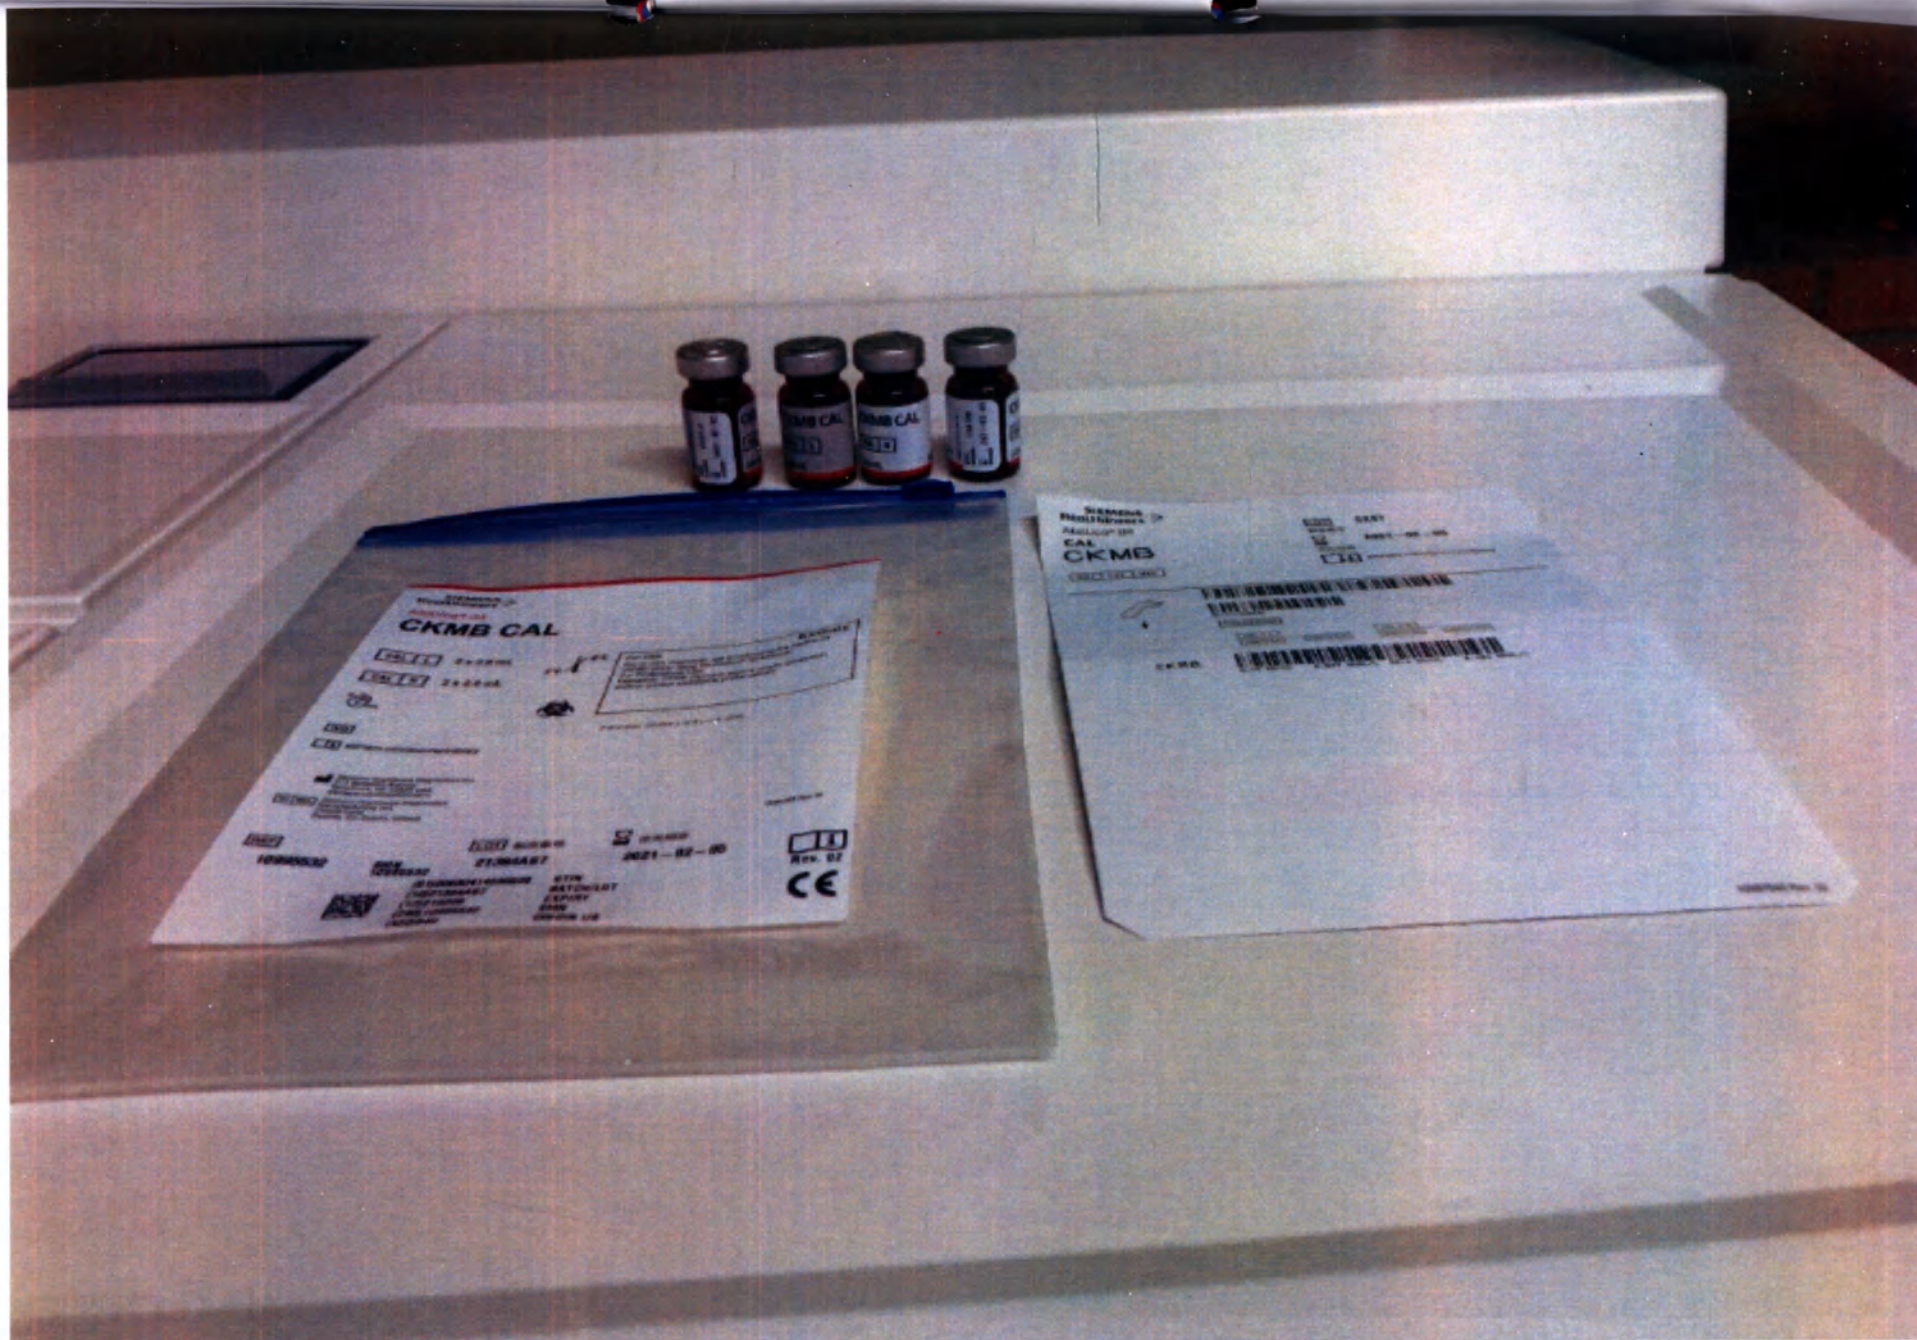


Рисунок 1. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)). Общий вид



Рисунок 2. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CKMB CAL H, 2,0 мл.

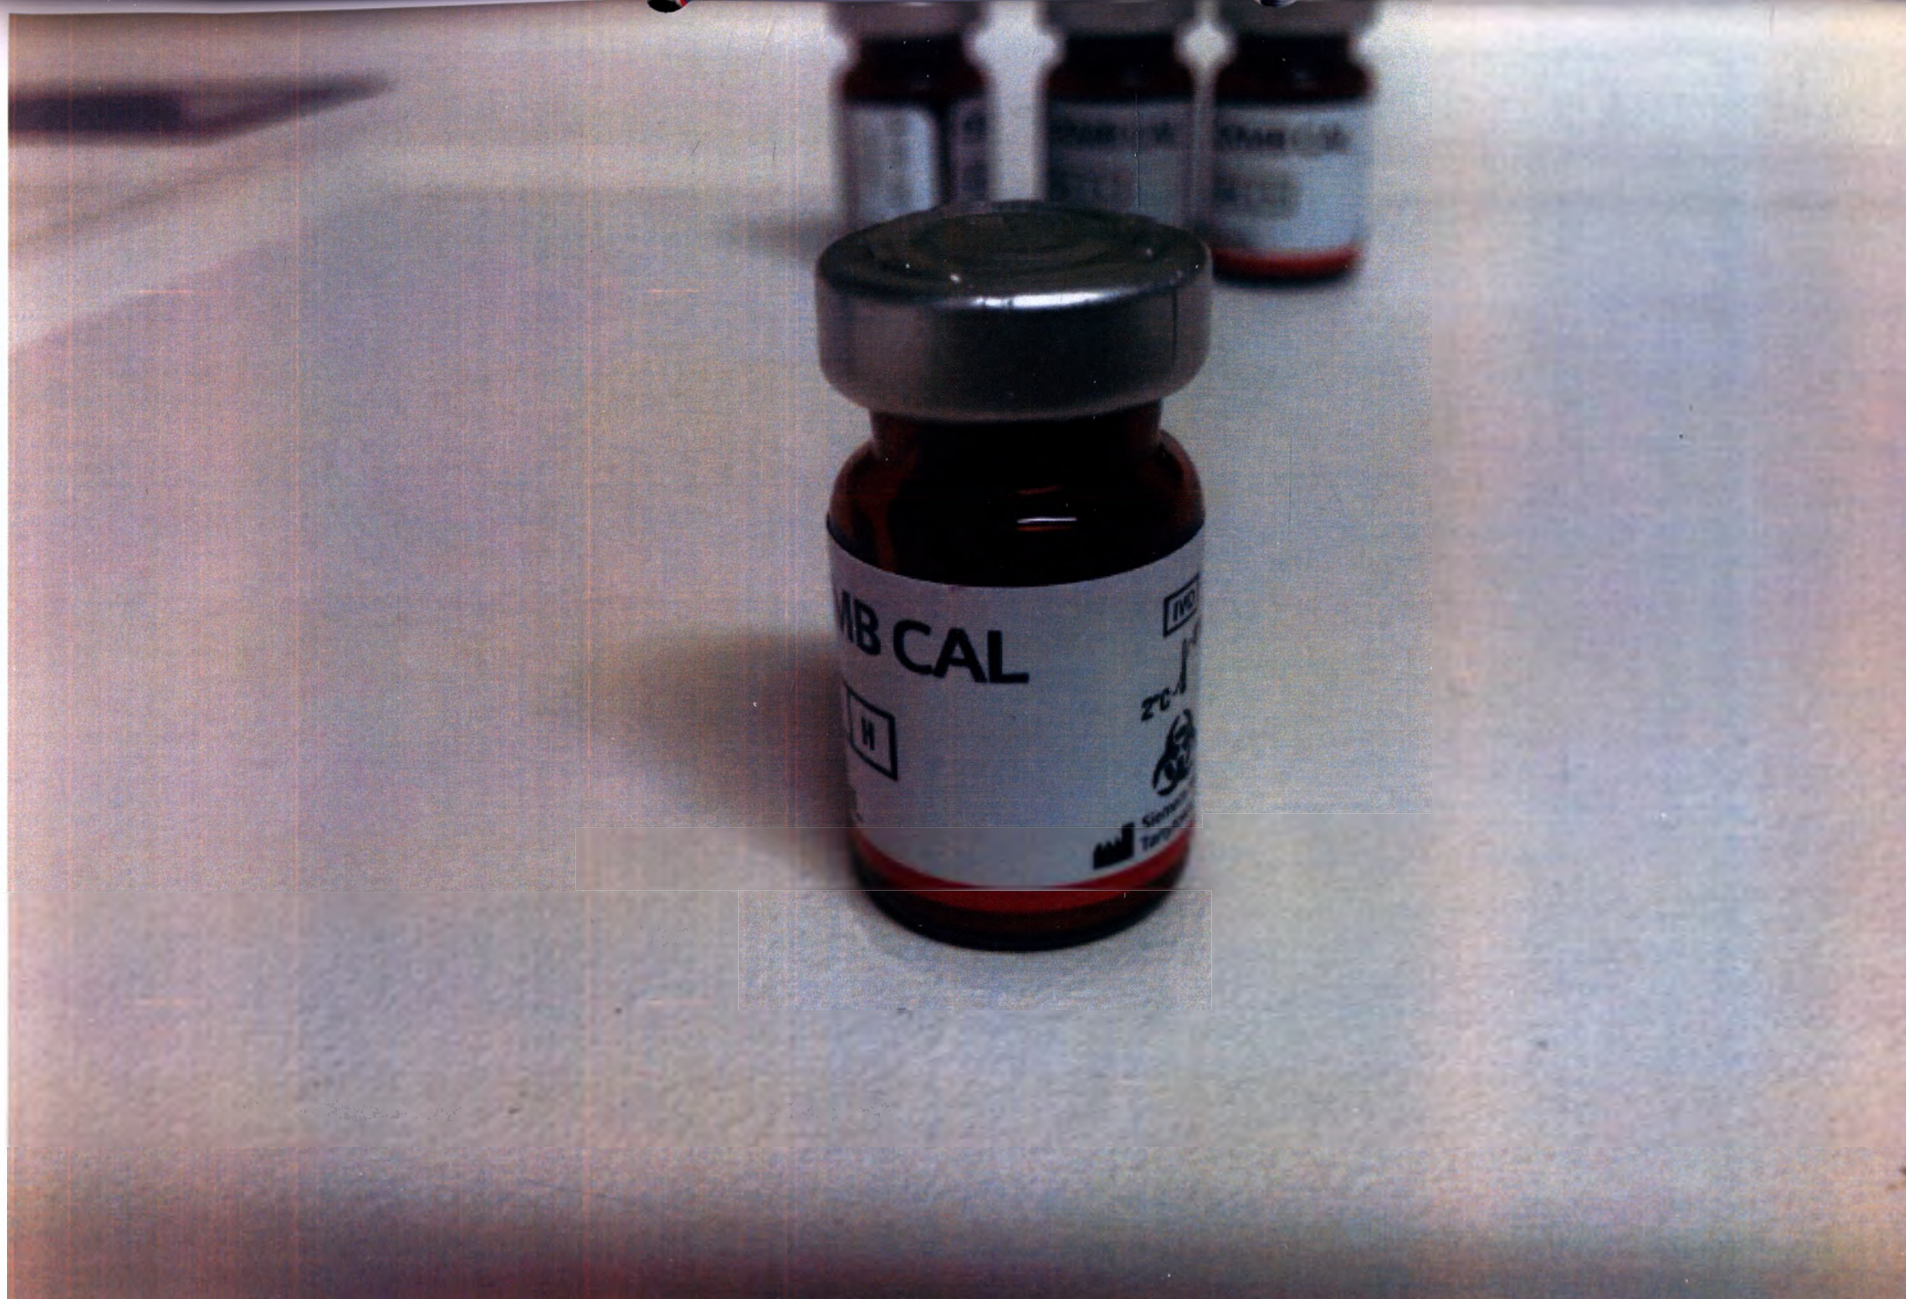


Рисунок 3. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CKMB CAL H, 2,0 мл.

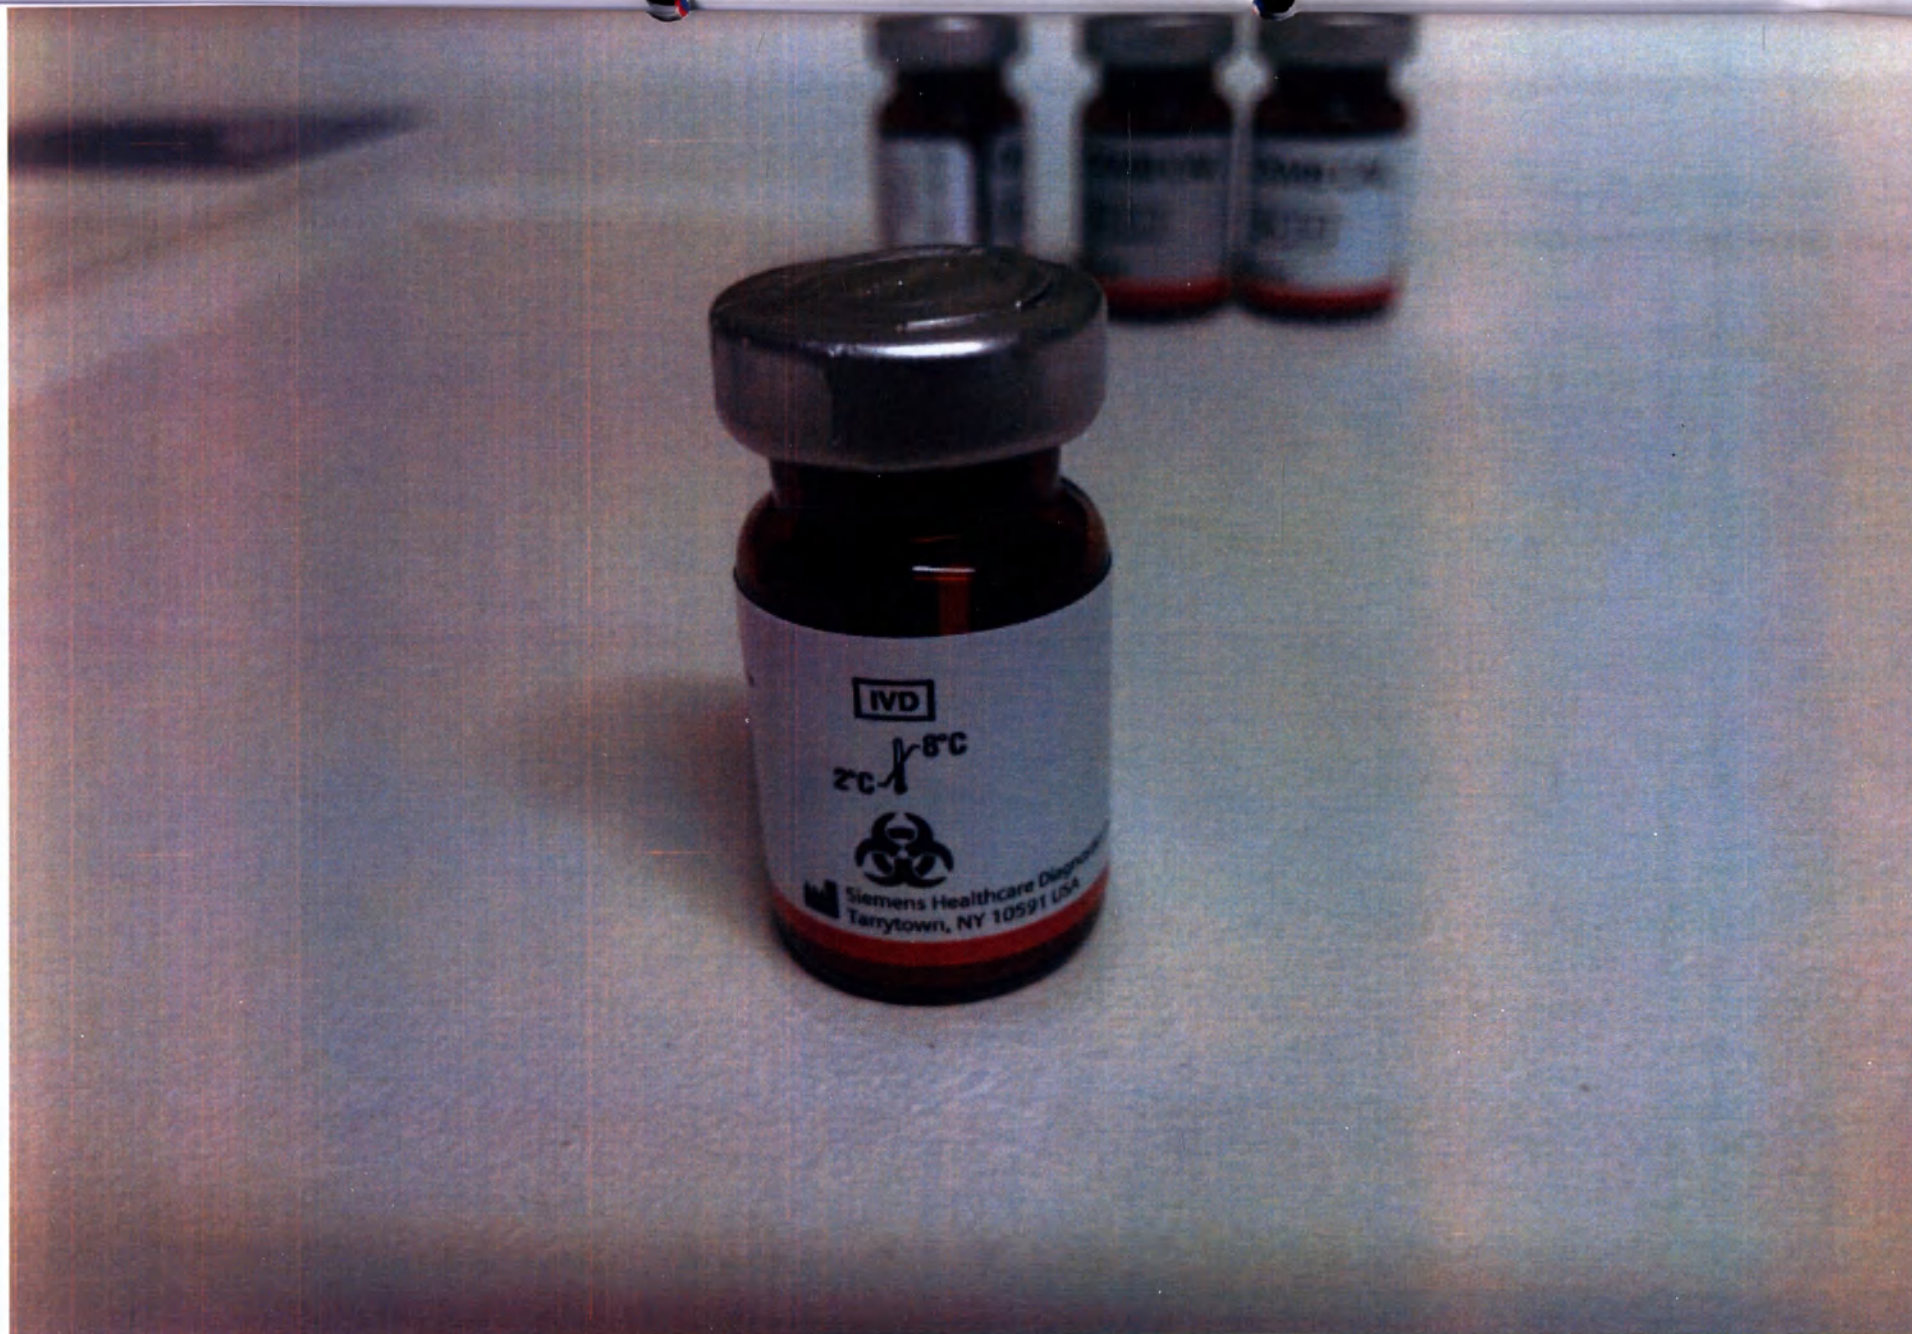


Рисунок 4. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CKMB CAL H, 2,0 мл.

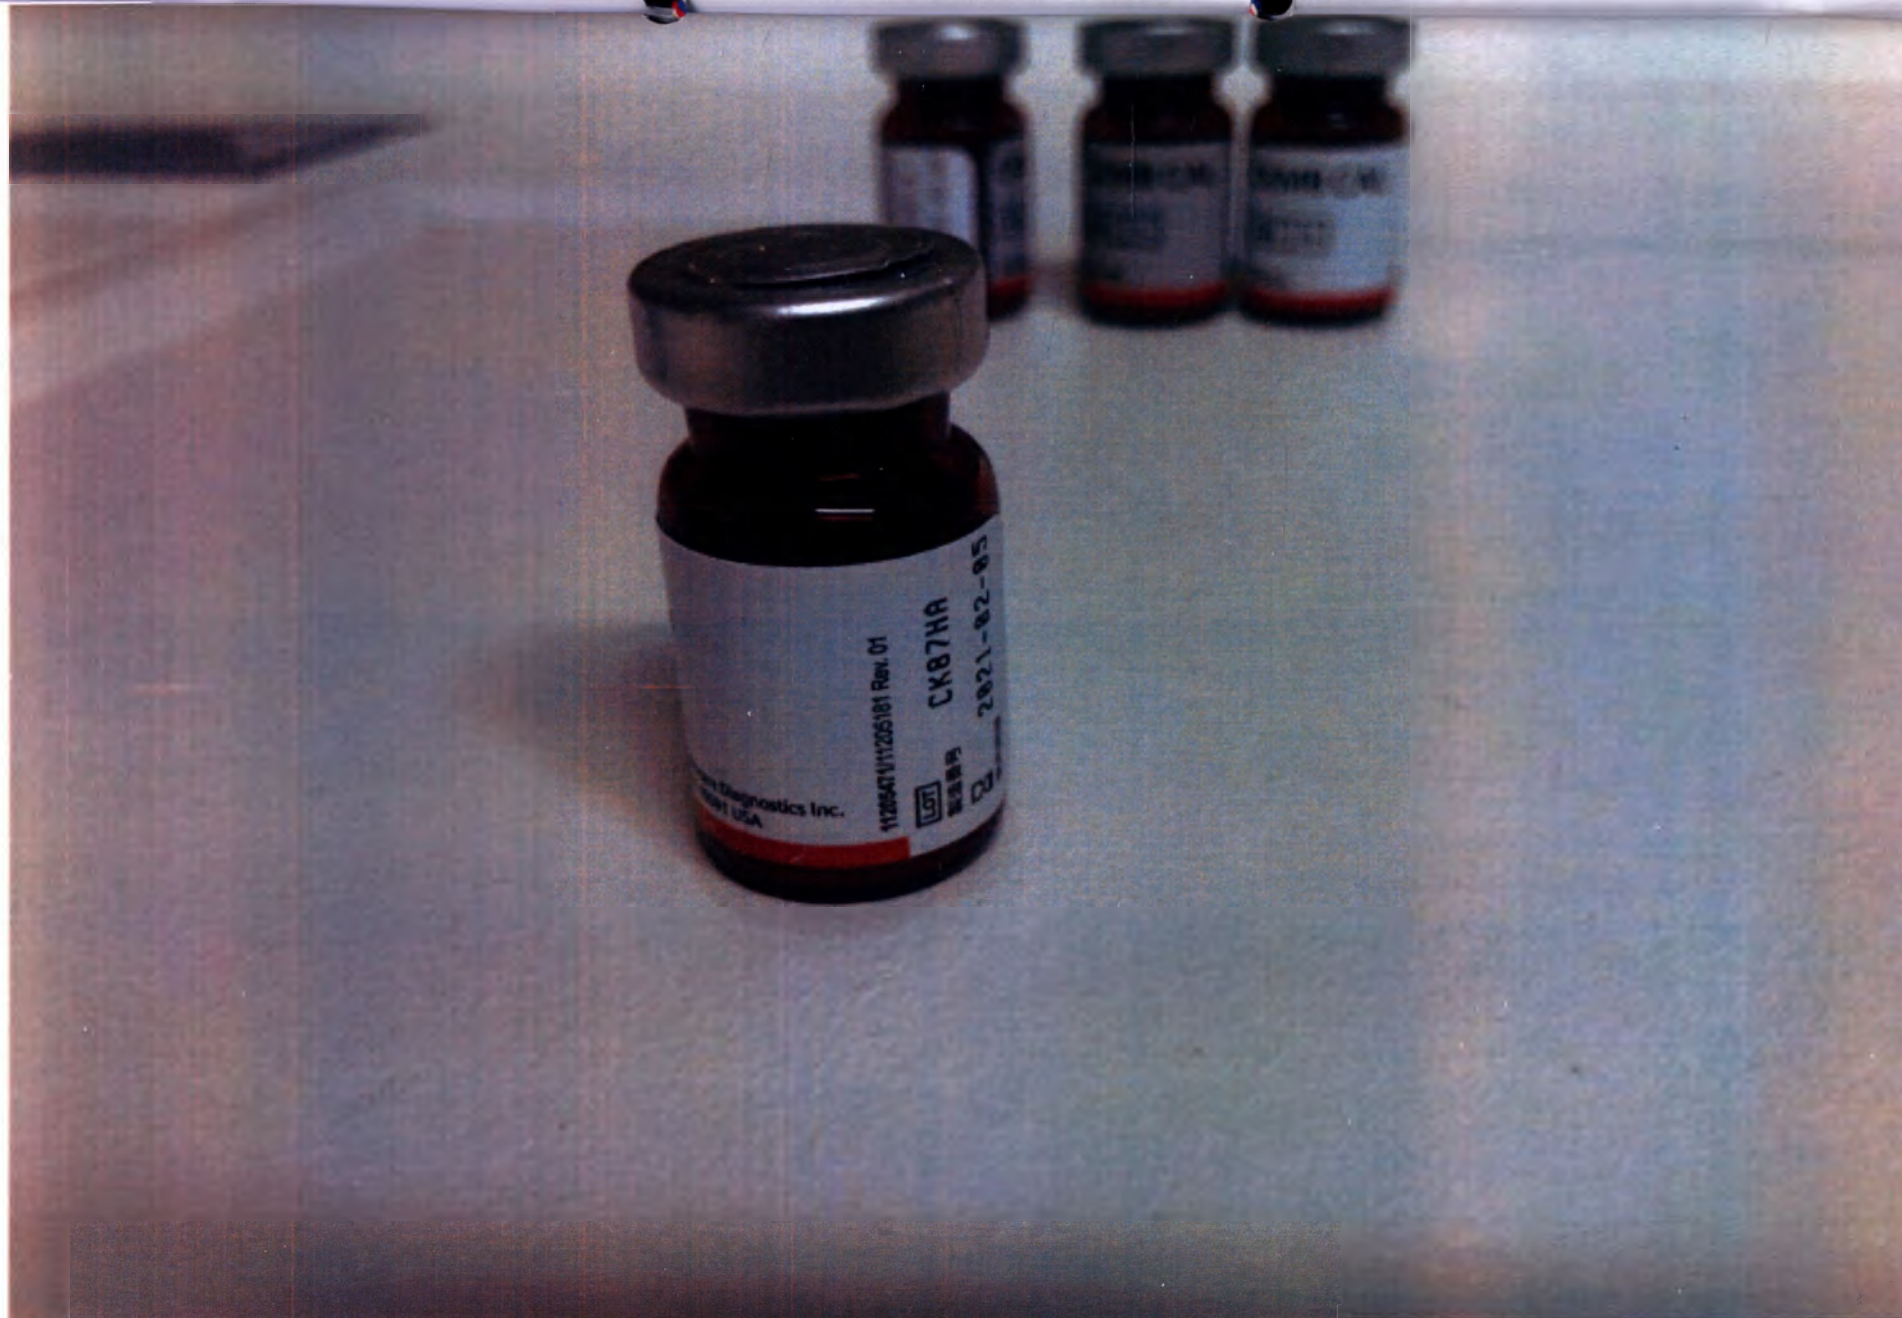


Рисунок 5. Набор калибраторов для определения креатинкиназы МВ для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM CKMB CAL H, 2,0 мл.

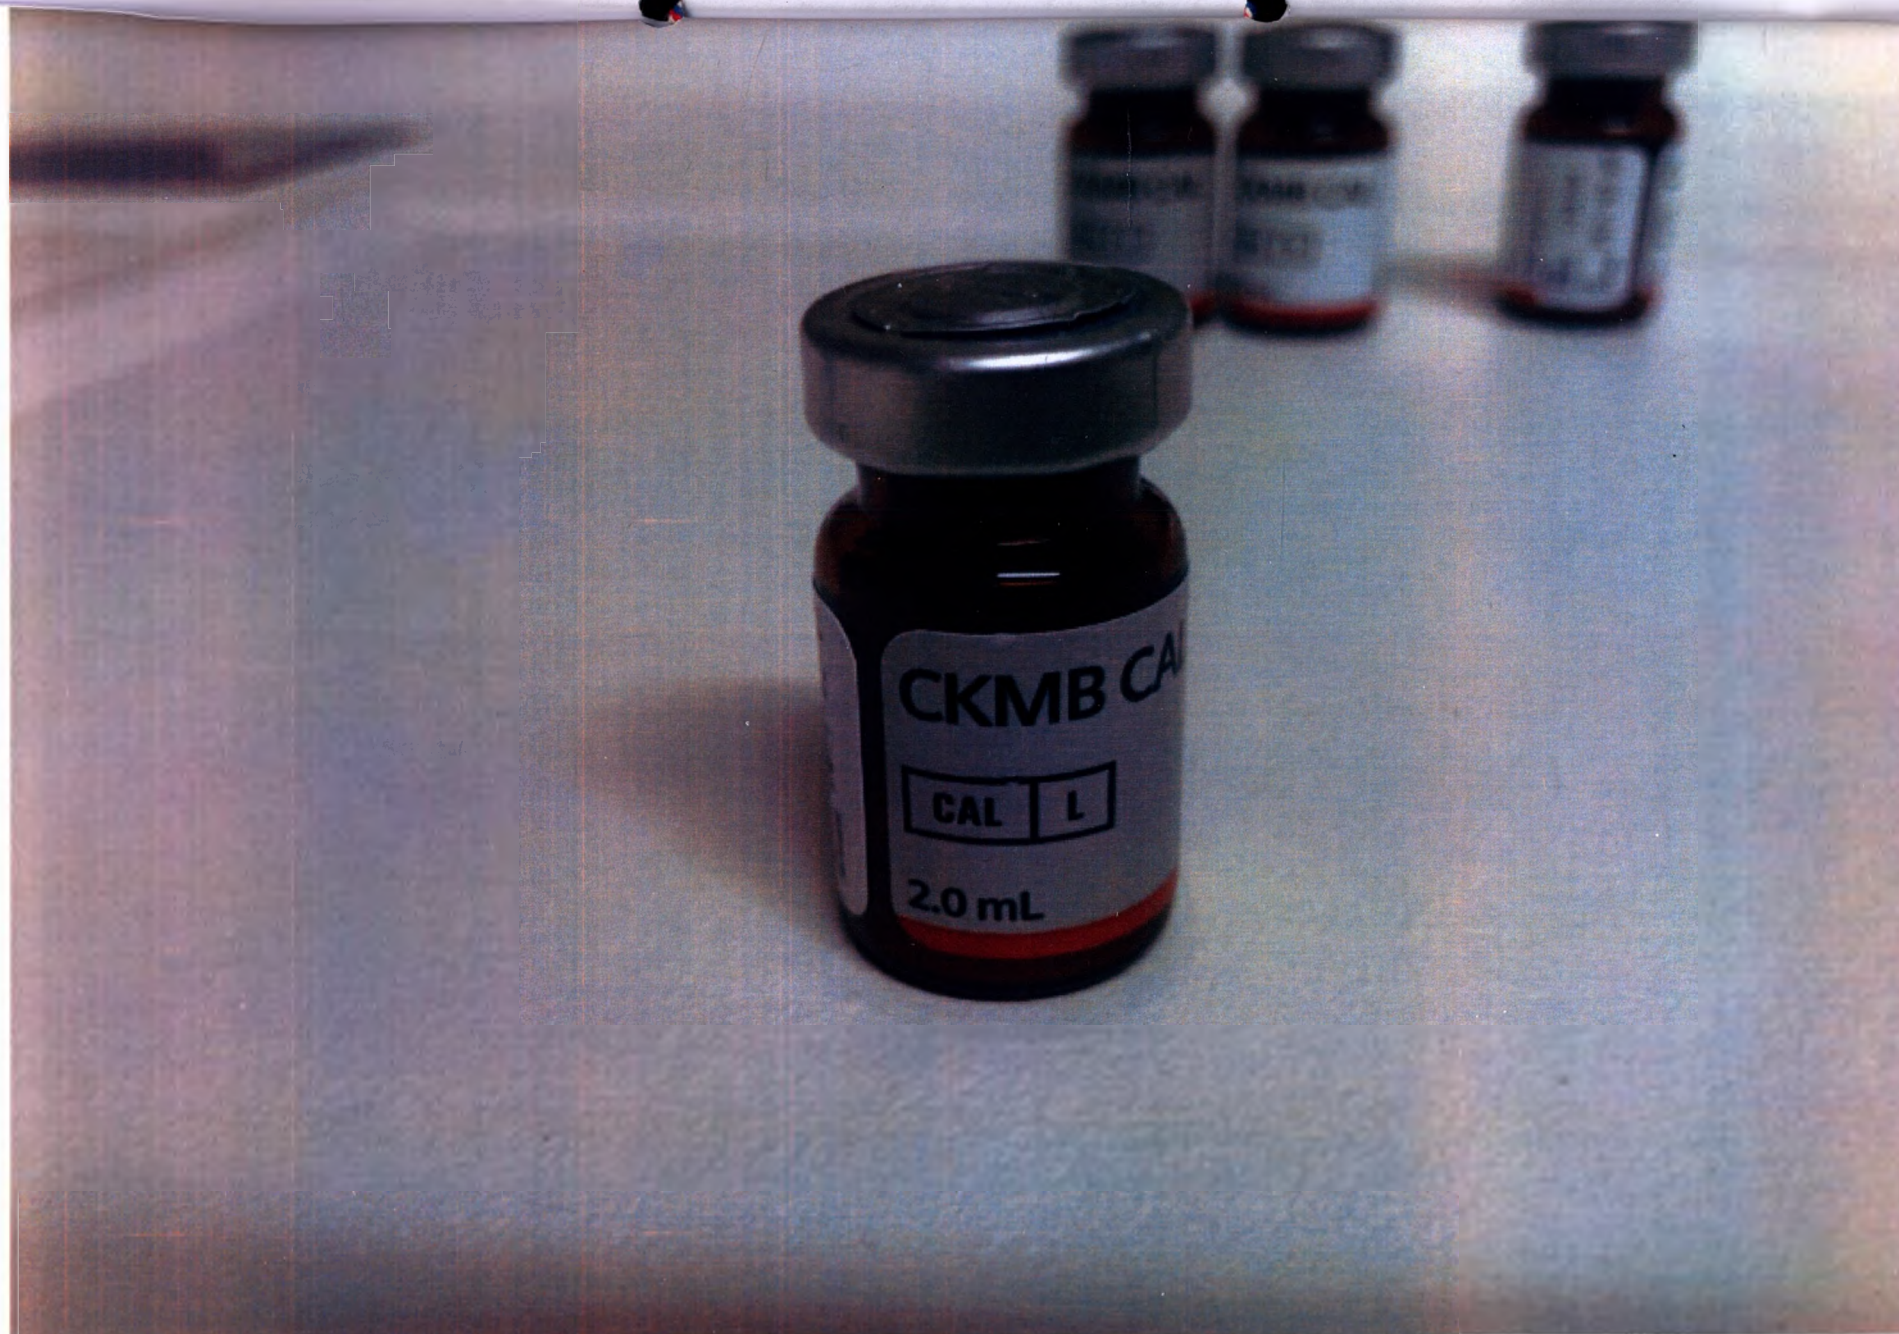


Рисунок 6. Набор калибраторов для определения креатинкиназы МВ для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CKMB CAL L, 2,0 мл

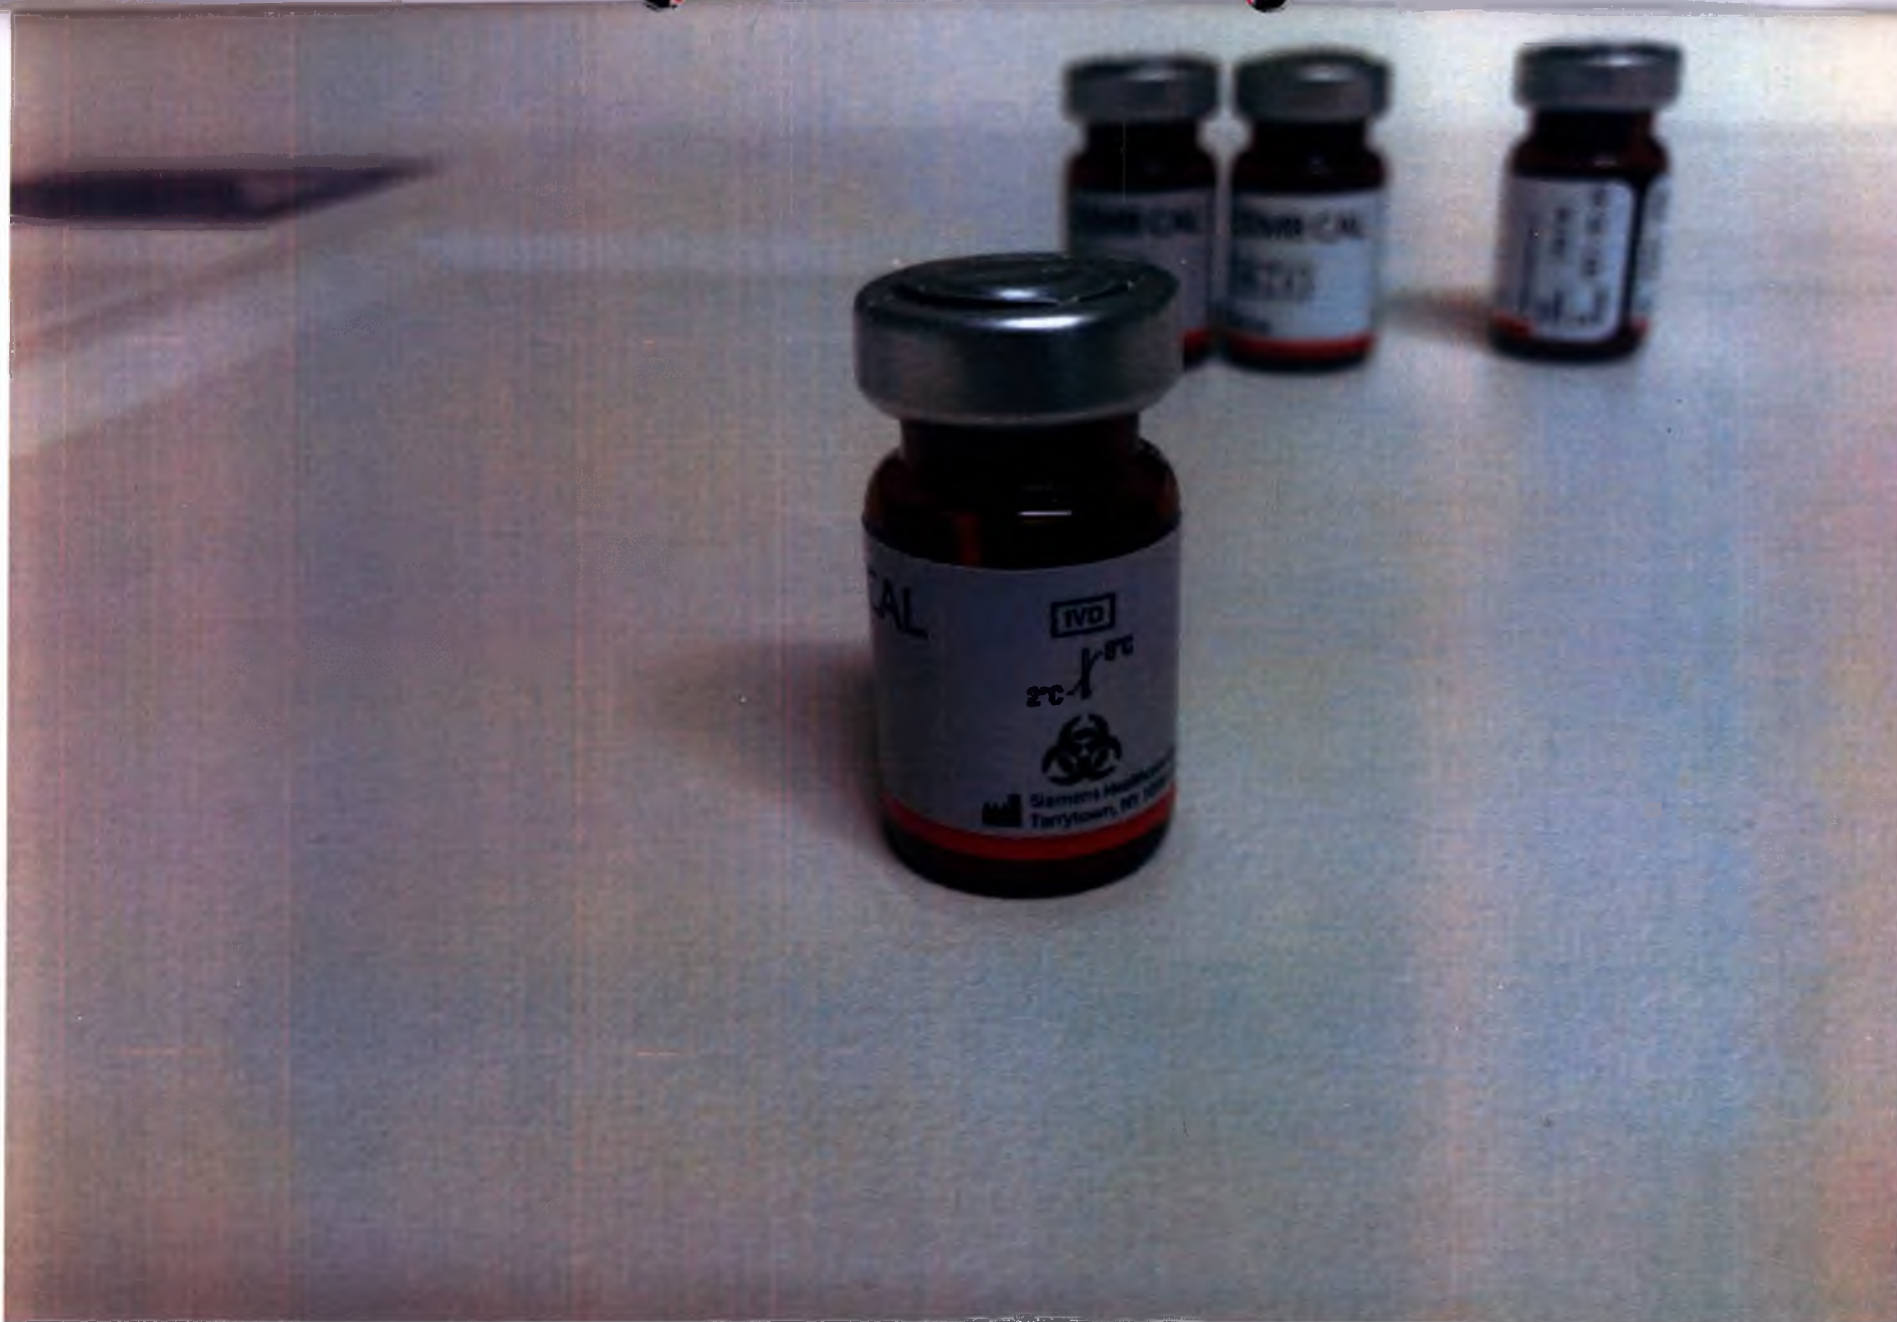


Рисунок 7. Набор калибраторов для определения креатинкиназы МВ для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CKMB CAL L, 2,0 мл

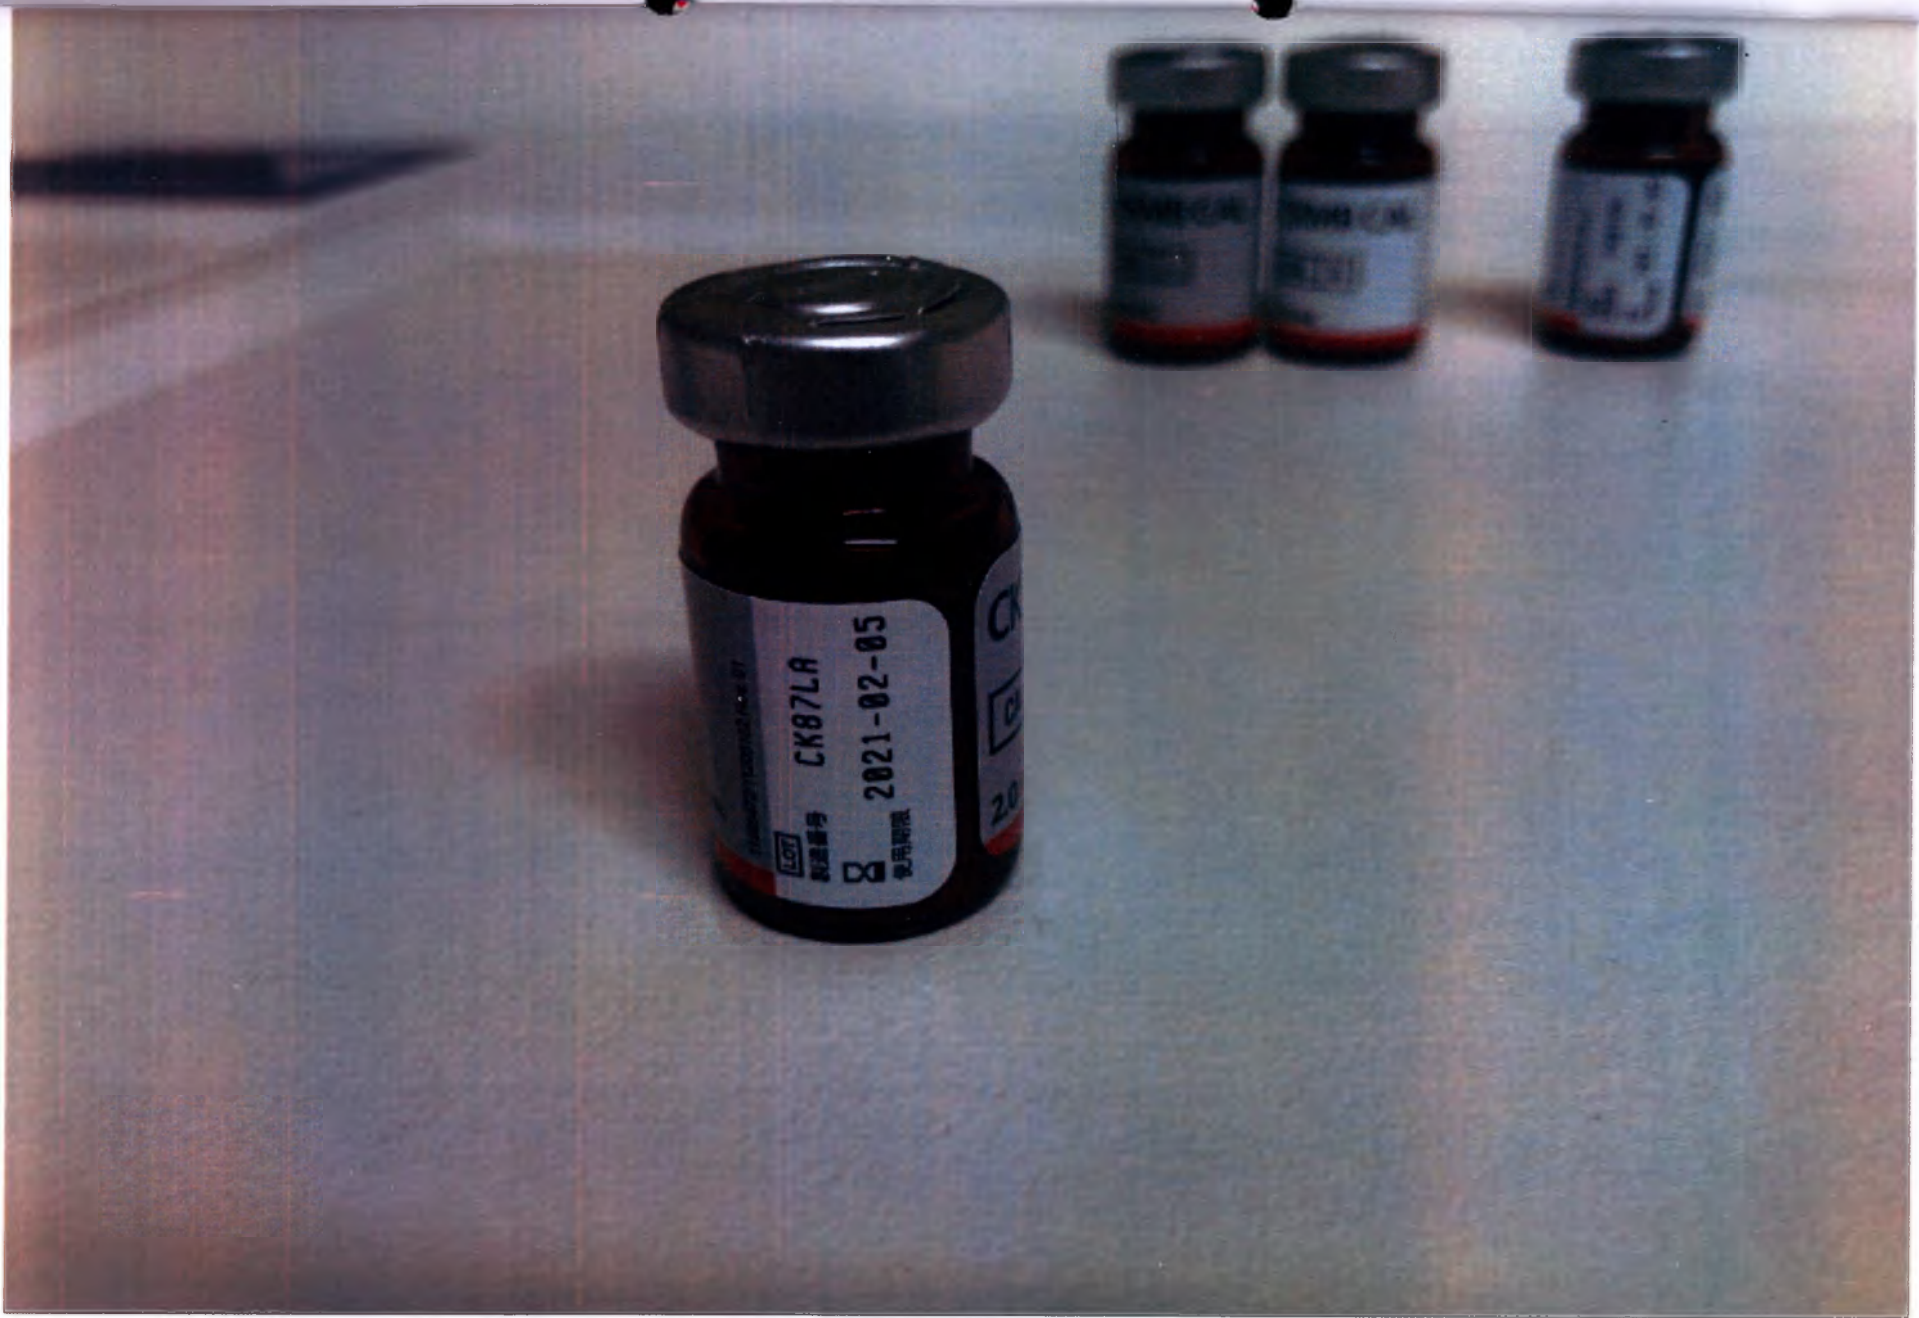


Рисунок 8. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM CKMB CAL L, 2,0 мл

Atellica® IM

CAL CKMB

LOT CK87

製造番号 2021-02-05

使用期限

[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)

↓

9fc14356

CHECKSUM

CAL I	CAL B
UNITS C	UNITS C
UNITS SI	UNITS SI

CKMB

3.74 NG/ML 6.807 MMOL/L 32.1 NG/ML 6.403 MMOL/L

CKMB CAL Rev. 02

Рисунок 9. Набор калибраторов для определения креатинкиназы MB для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (Atellica IM CKMB CAL)): Лист значений параметров серии калибратора



Всего прошито и пронумеровано
10 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

