

214

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Эмера»



Н. С. Сидорова

2014 г.

Комплект фотографических изображений
составных частей и принадлежностей

**«Системы кардио-респираторной нагрузочной диагностики,
варианты исполнения MetaLyzer 3, MetaSwim, MetaMax 3B»
с принадлежностями**

Разработчик:


"CORTEX Biophysik GmbH", Walter-Köhn-Str. 2 d, D-04356 Leipzig, Germany.
КОРТЕКС Биофизик ГмбХ», Лейпциг, Германия.

Производитель:

"CORTEX Biophysik GmbH", Walter-Köhn-Str. 2 d, D-04356 Leipzig, Germany.
«КОРТЕКС Биофизик ГмбХ», Лейпциг, Германия.

1. БЛОК СИСТЕМНЫЙ:
1.1. Системный блок MetaLyzer 3B



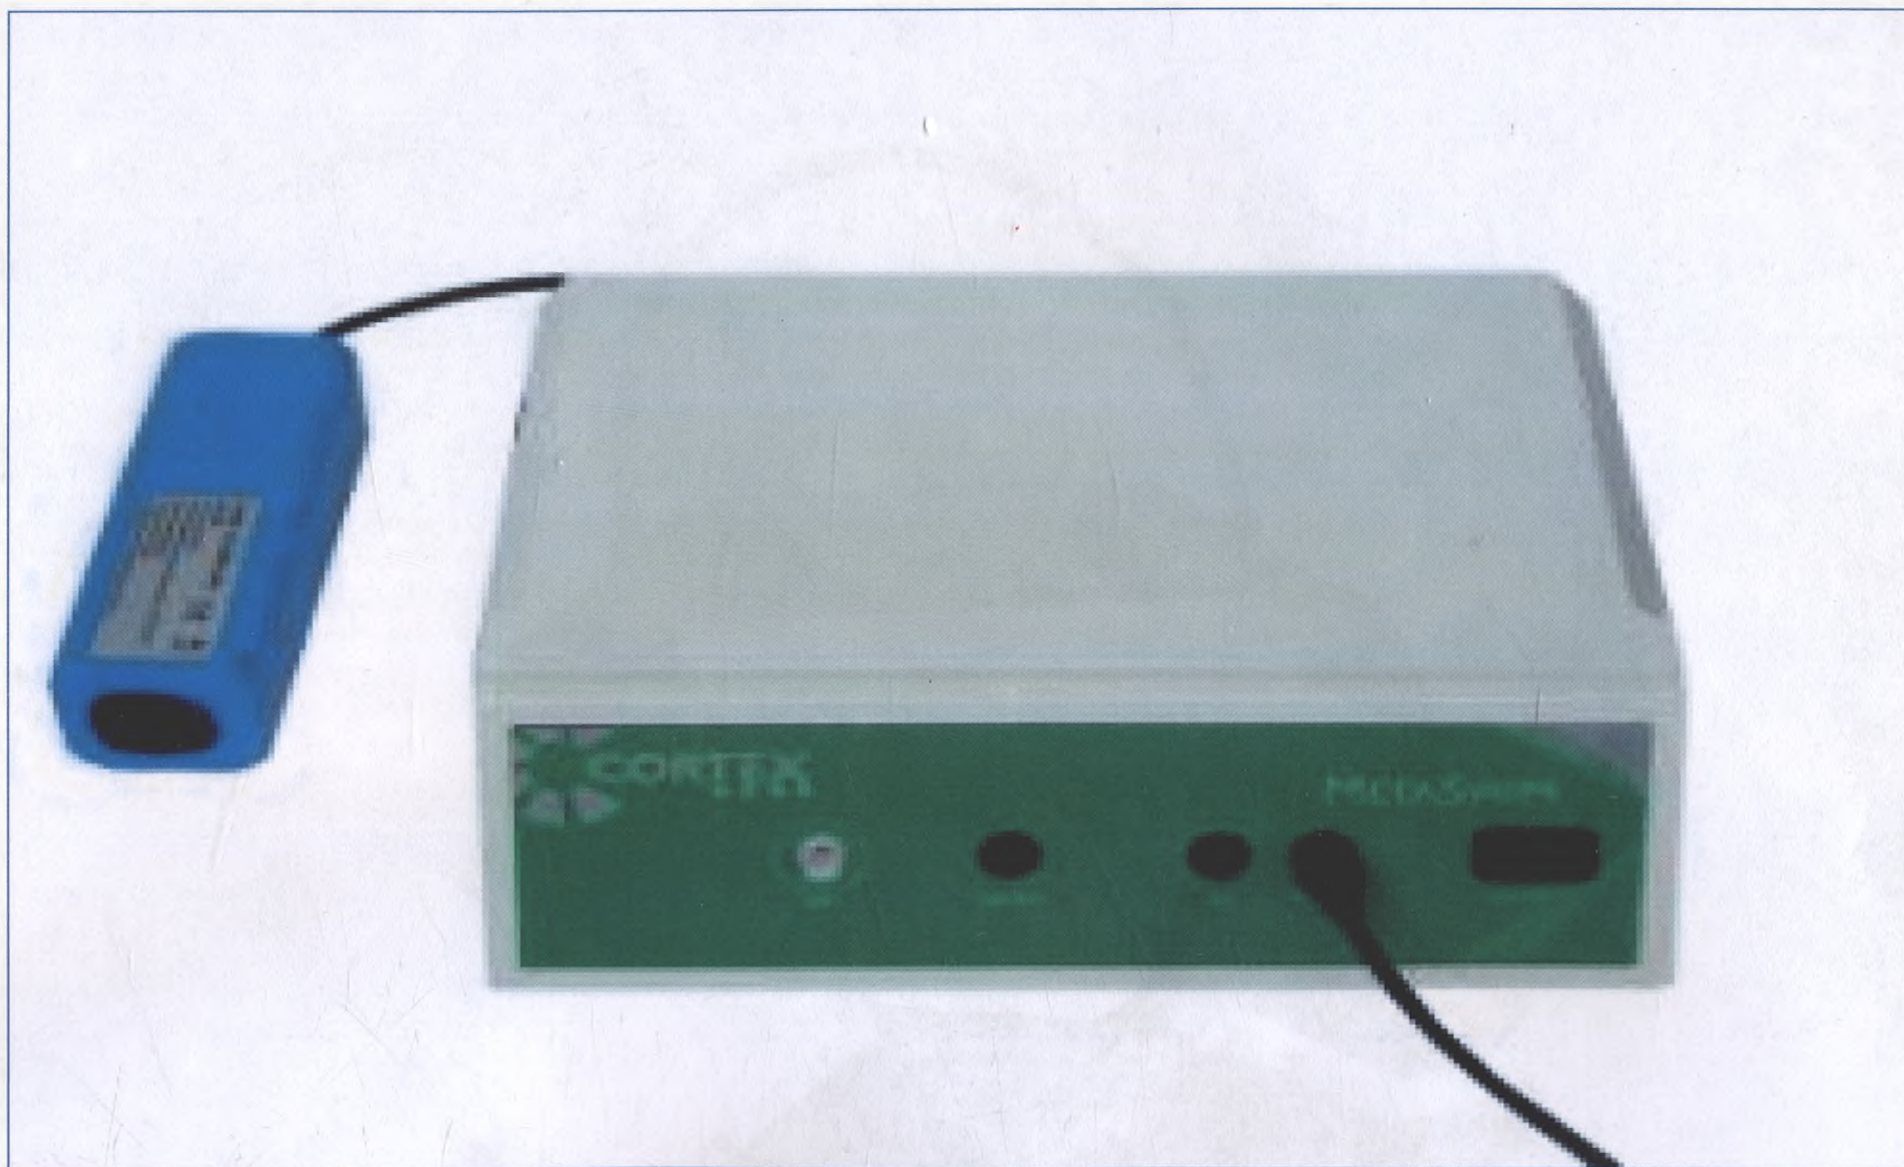



218

2. ЧЕМОДАН СИСТЕМНОГО БЛОКА:






3. БЛОК ТЕЛЕМЕТРИИ:

4. БЛОК ПИТАНИЯ:


22

5. КАБЕЛИ ПИТАНИЯ:

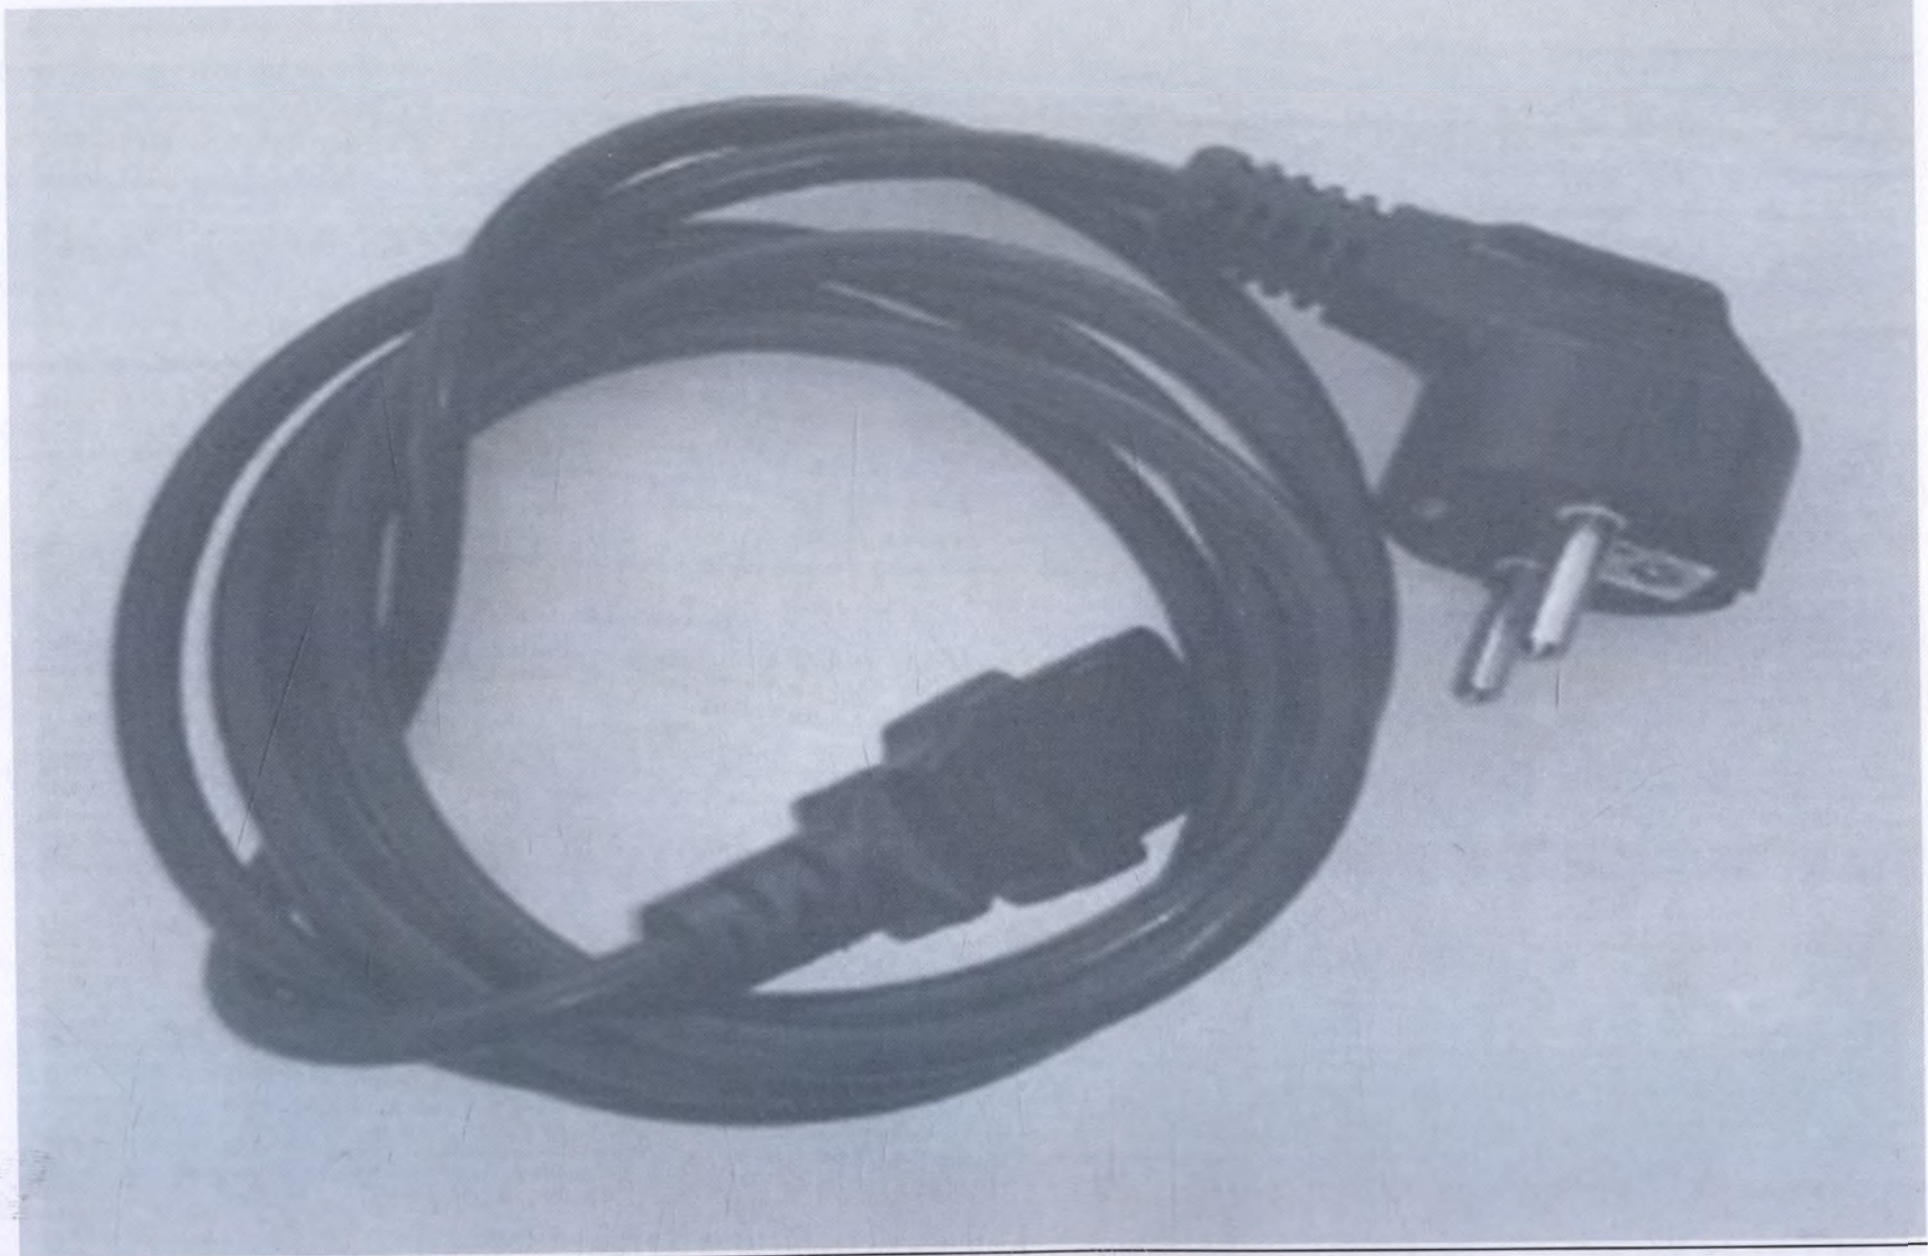


22

6. КАБЕЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БЛОКИ ТЕЛЕМЕТРИИ:

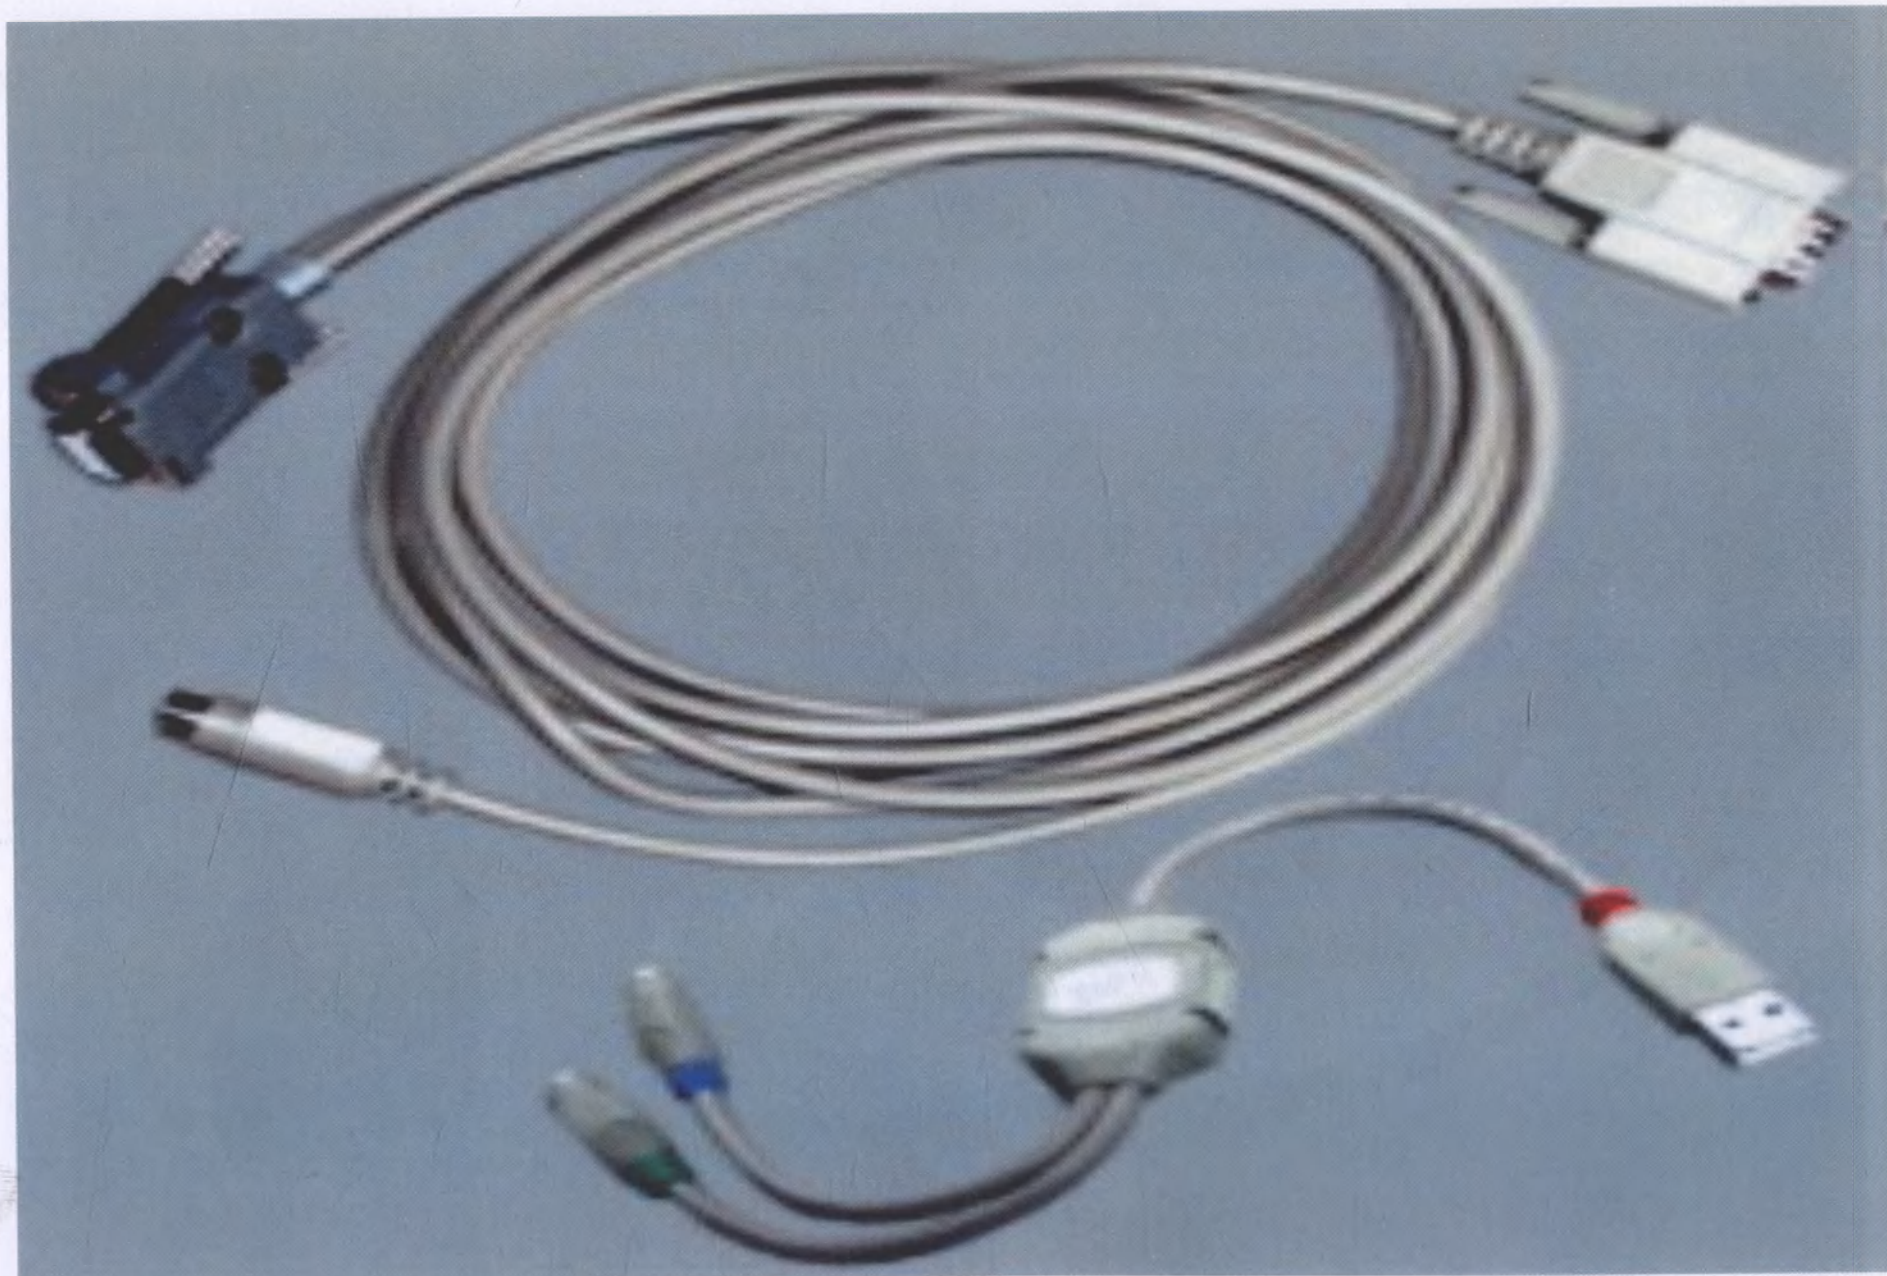

223

7. КАБЕЛИ РАСШИРЕНИЯ:

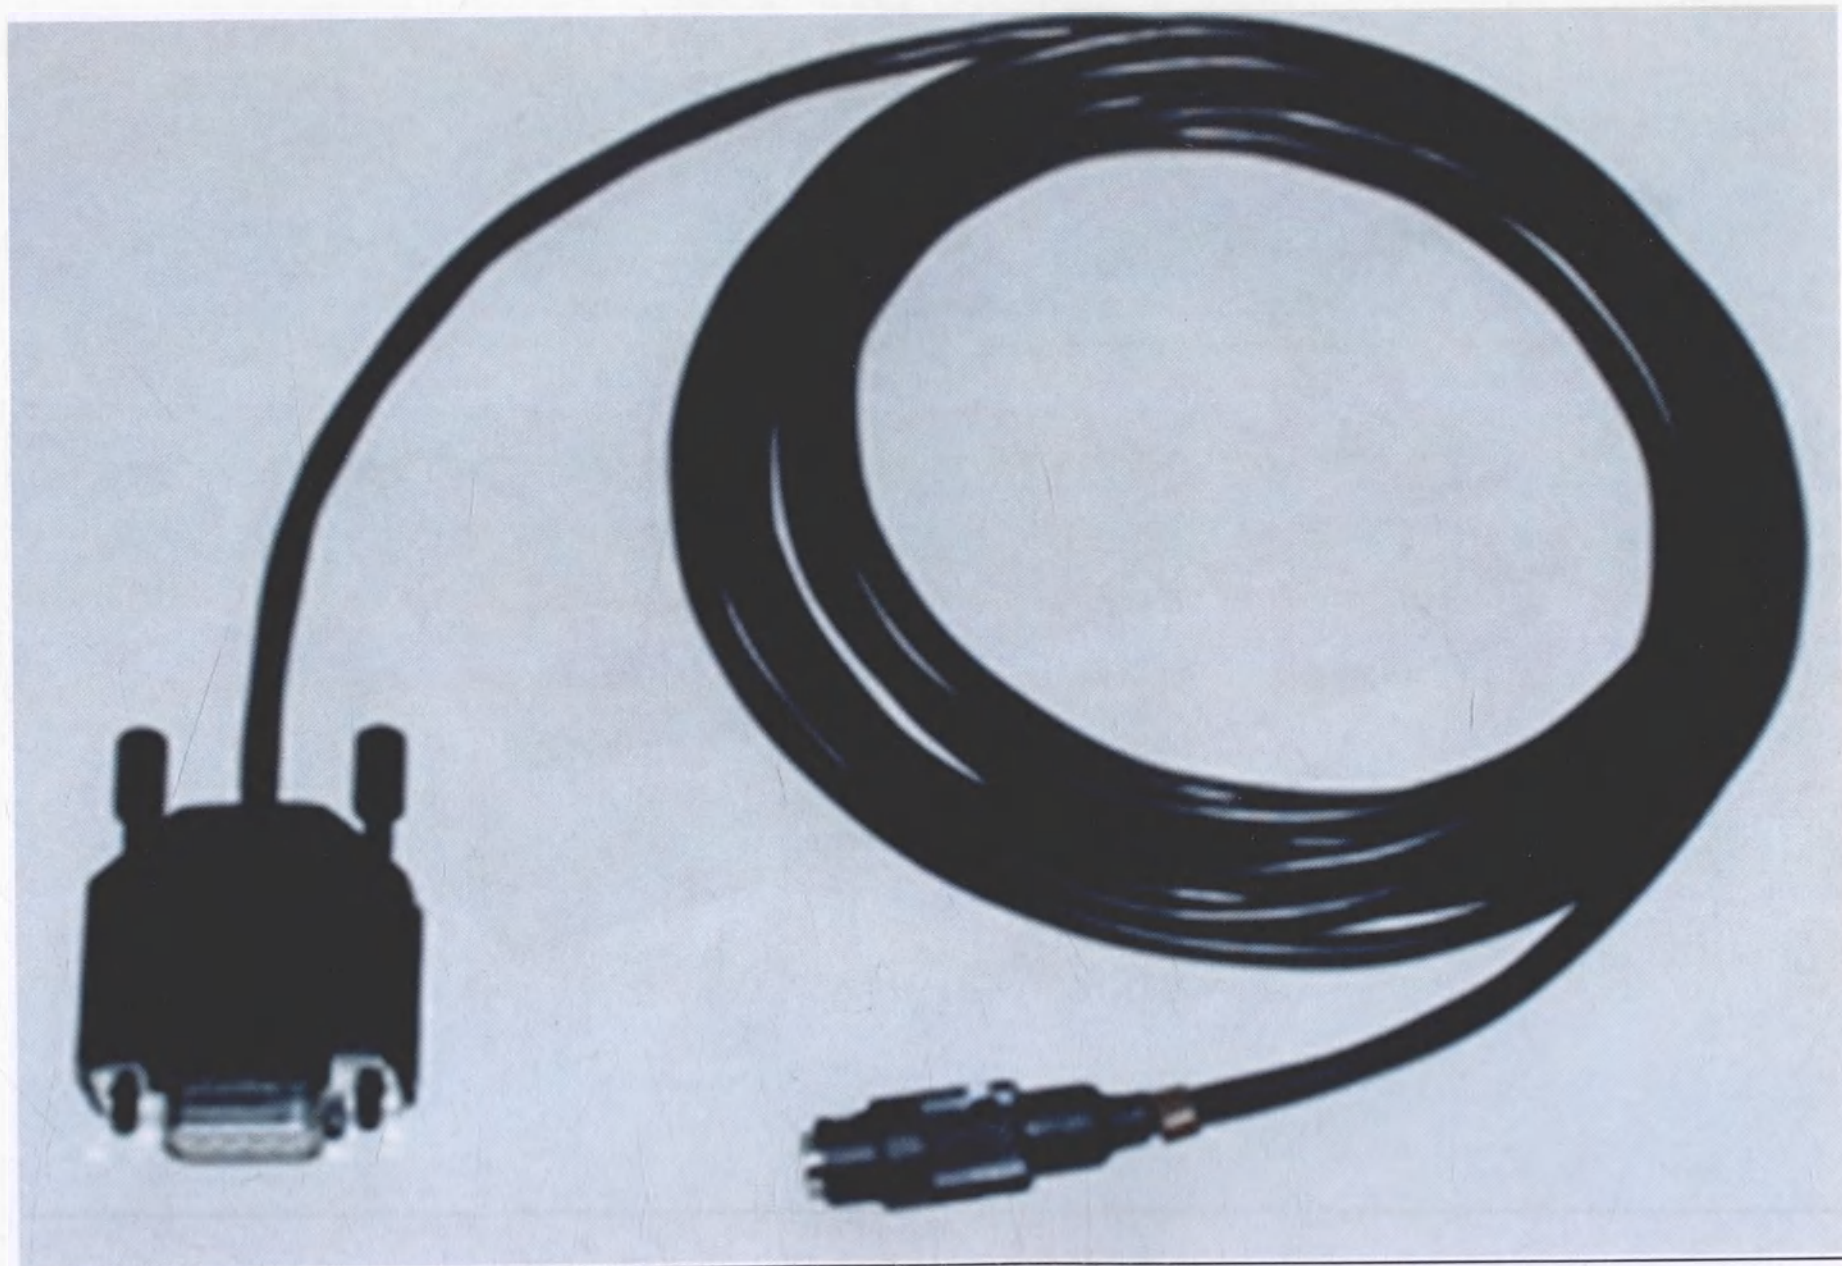



9. БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ:





11. КЛЮЧ ПРОГРАММНЫЙ ДЛЯ MetaSoft USB dongle:



820-40-010

USB/serial Converter
FTDI Chipsatz
Cable USB to serial
for all serial devices

- Easy connection of serial devices through an USB port
- Data transfer rates 1Mbps and more
- Supports remote wake-up and power management
- Can be used for PDA, modems and more



USB TO SERIA

229

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1. Обеспечение программное MetaSoft на CD-диске:



230

2. Лицензия активационная metacontrol 3000:

БЕЗ ФОТО.

Активационная лицензия для подключения оболочки взаимодействия с ЭКГ.


Представляет собой цифровой код, напечатанный на листе бумаги.

3. Лицензия активационная для сетевой версии:

БЕЗ ФОТО.

Данная лицензия позволяет зарегистрировать продукт в интернете, получать новейшие обновления для программного обеспечения.

Представляет собой цифровой код, напечатанный на листе бумаги.

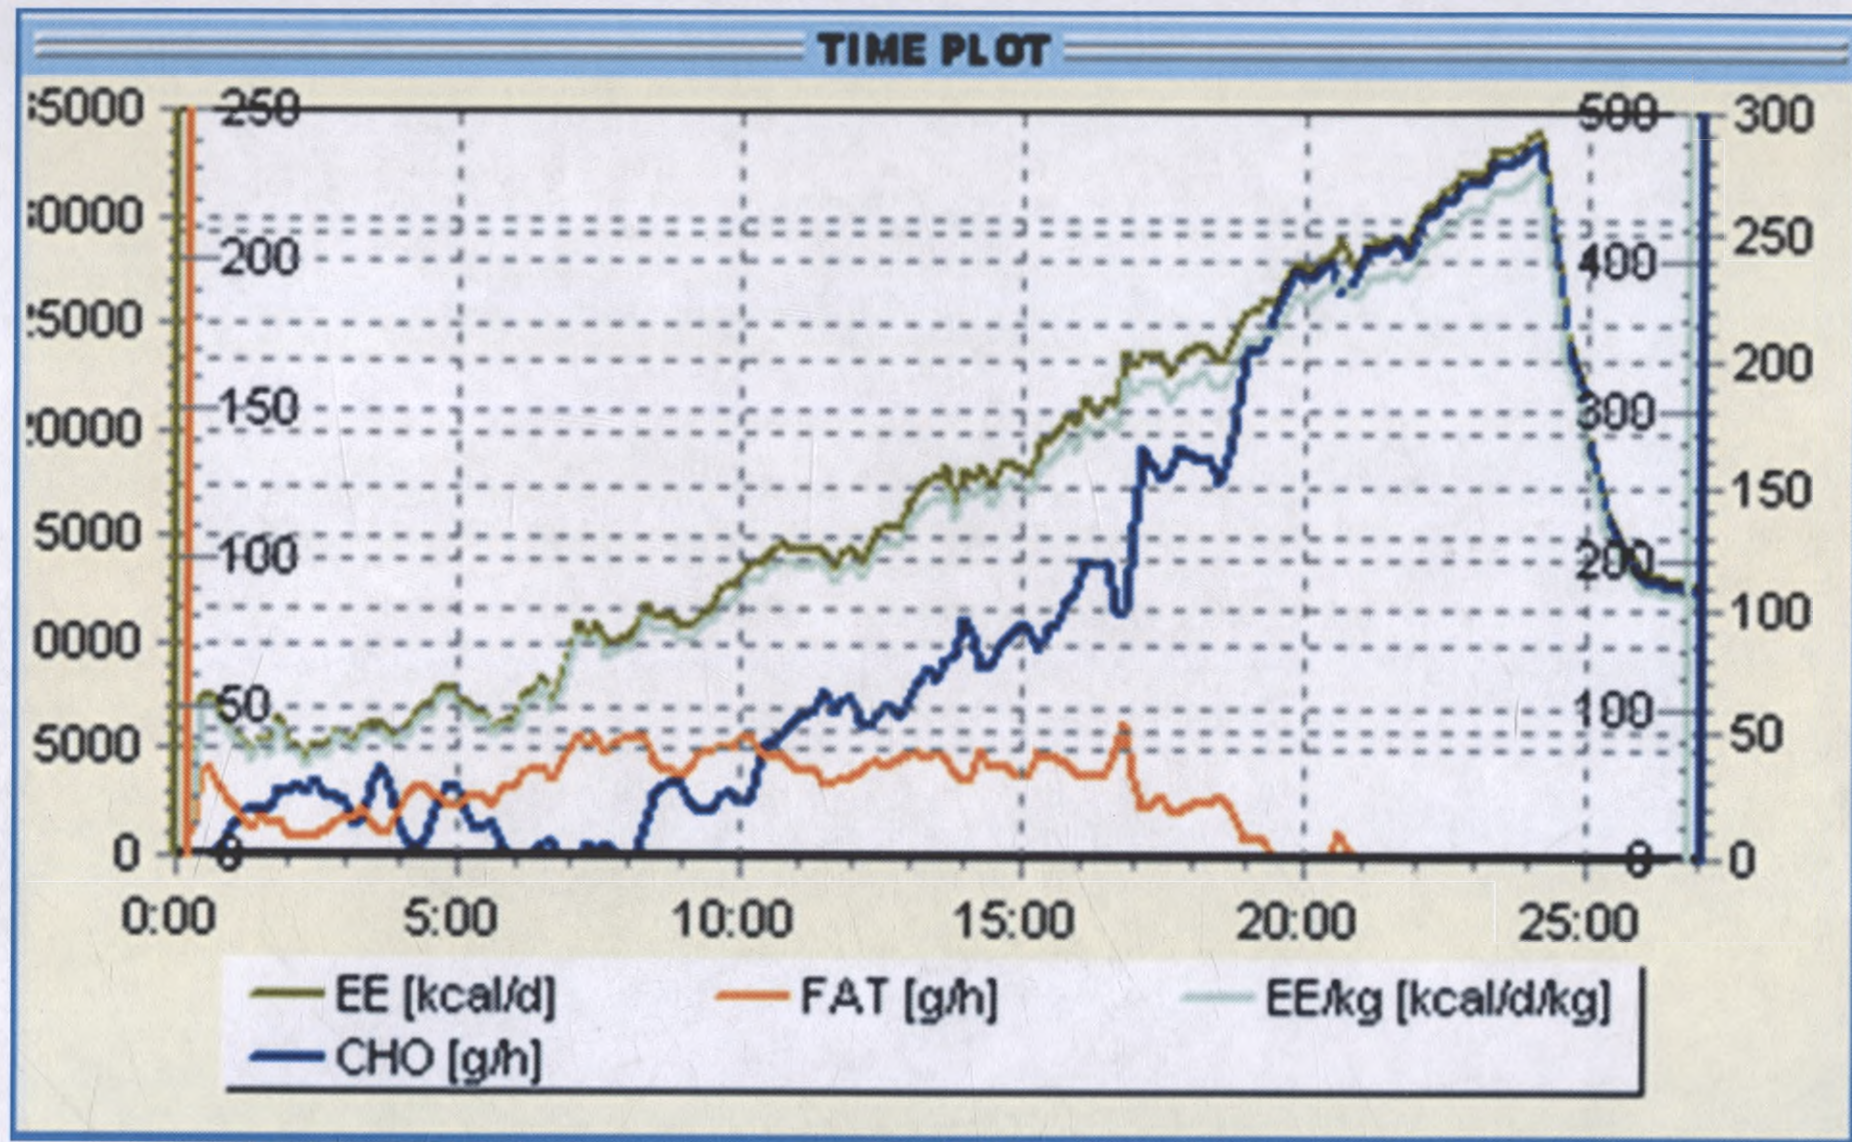

5. Опция программного обеспечения Максимальная Производительность на CD-диске:



BMR/RMR Test Settings

Test Type Name

Resting Metabolic Rate (RMR)

Steady State Conditions

Variation $\dot{V}O_2$	< $\pm$	5,00 %
Variation $\dot{V}CO_2$	< $\pm$	6,74 %
Variation RQ	< $\pm$	6,77 %
Duration		03:00 [mm:ss]

Online Averaging

9 Breaths

Nutritional Assessment Options


Metabolic Calculation Method:

Based on Measured RQ

Protein Utilization:

Based on Assumed Protein Utilization (15 %)



Substrate Utilization

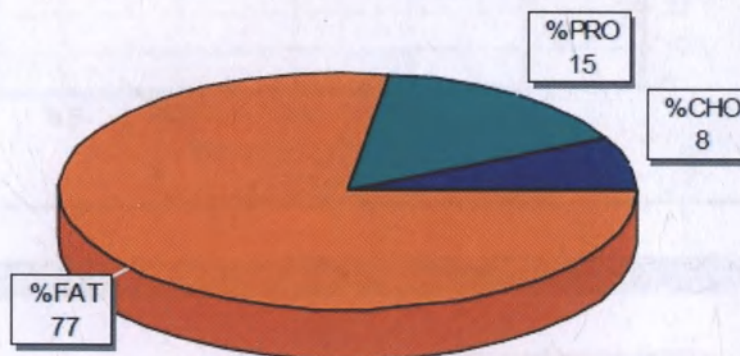


Calculated Parameter Averages

$\dot{V}O_2$:	0,430 l/min
$\dot{V}CO_2$:	0,317 l/min
RQ:	0,74

154

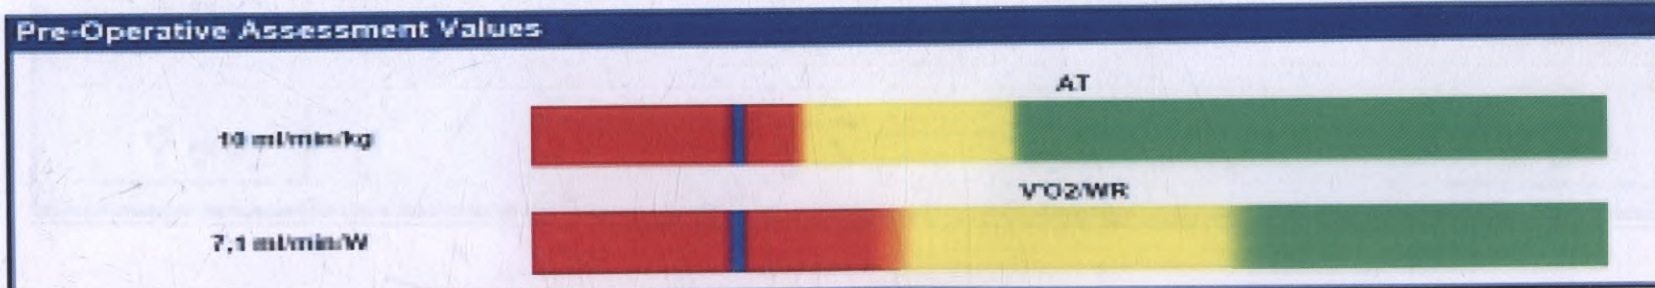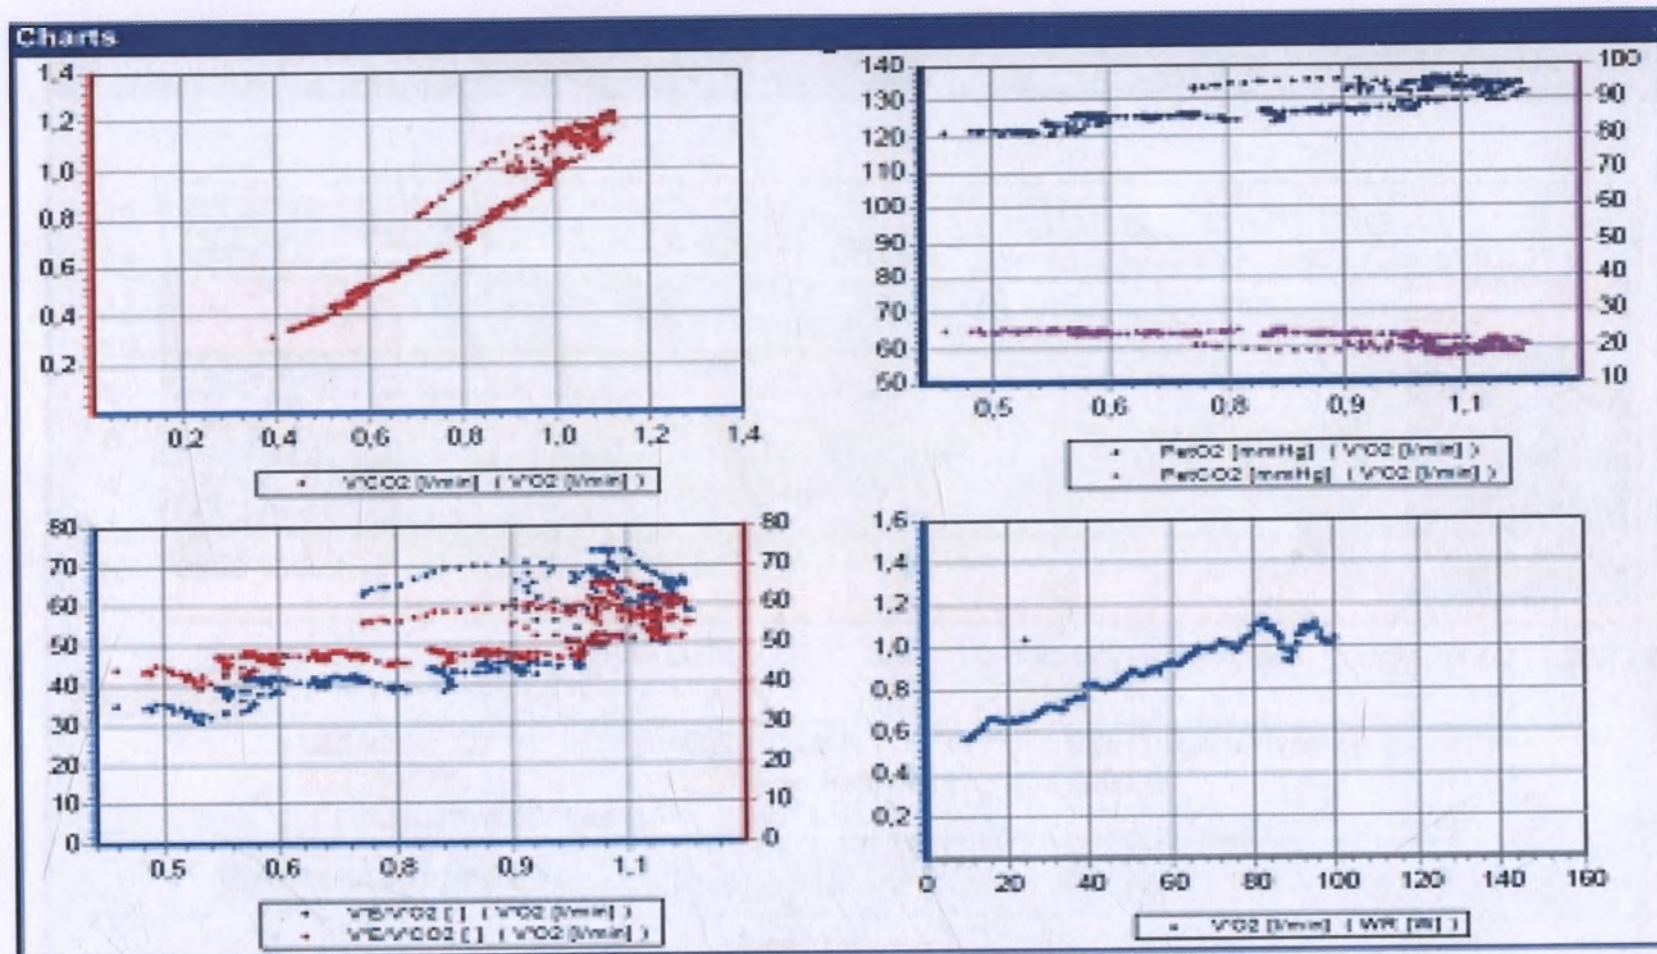


982
8. Опция программного обеспечения Оценка Риска для пациентов с сердечной недостаточностью на CD-диске:

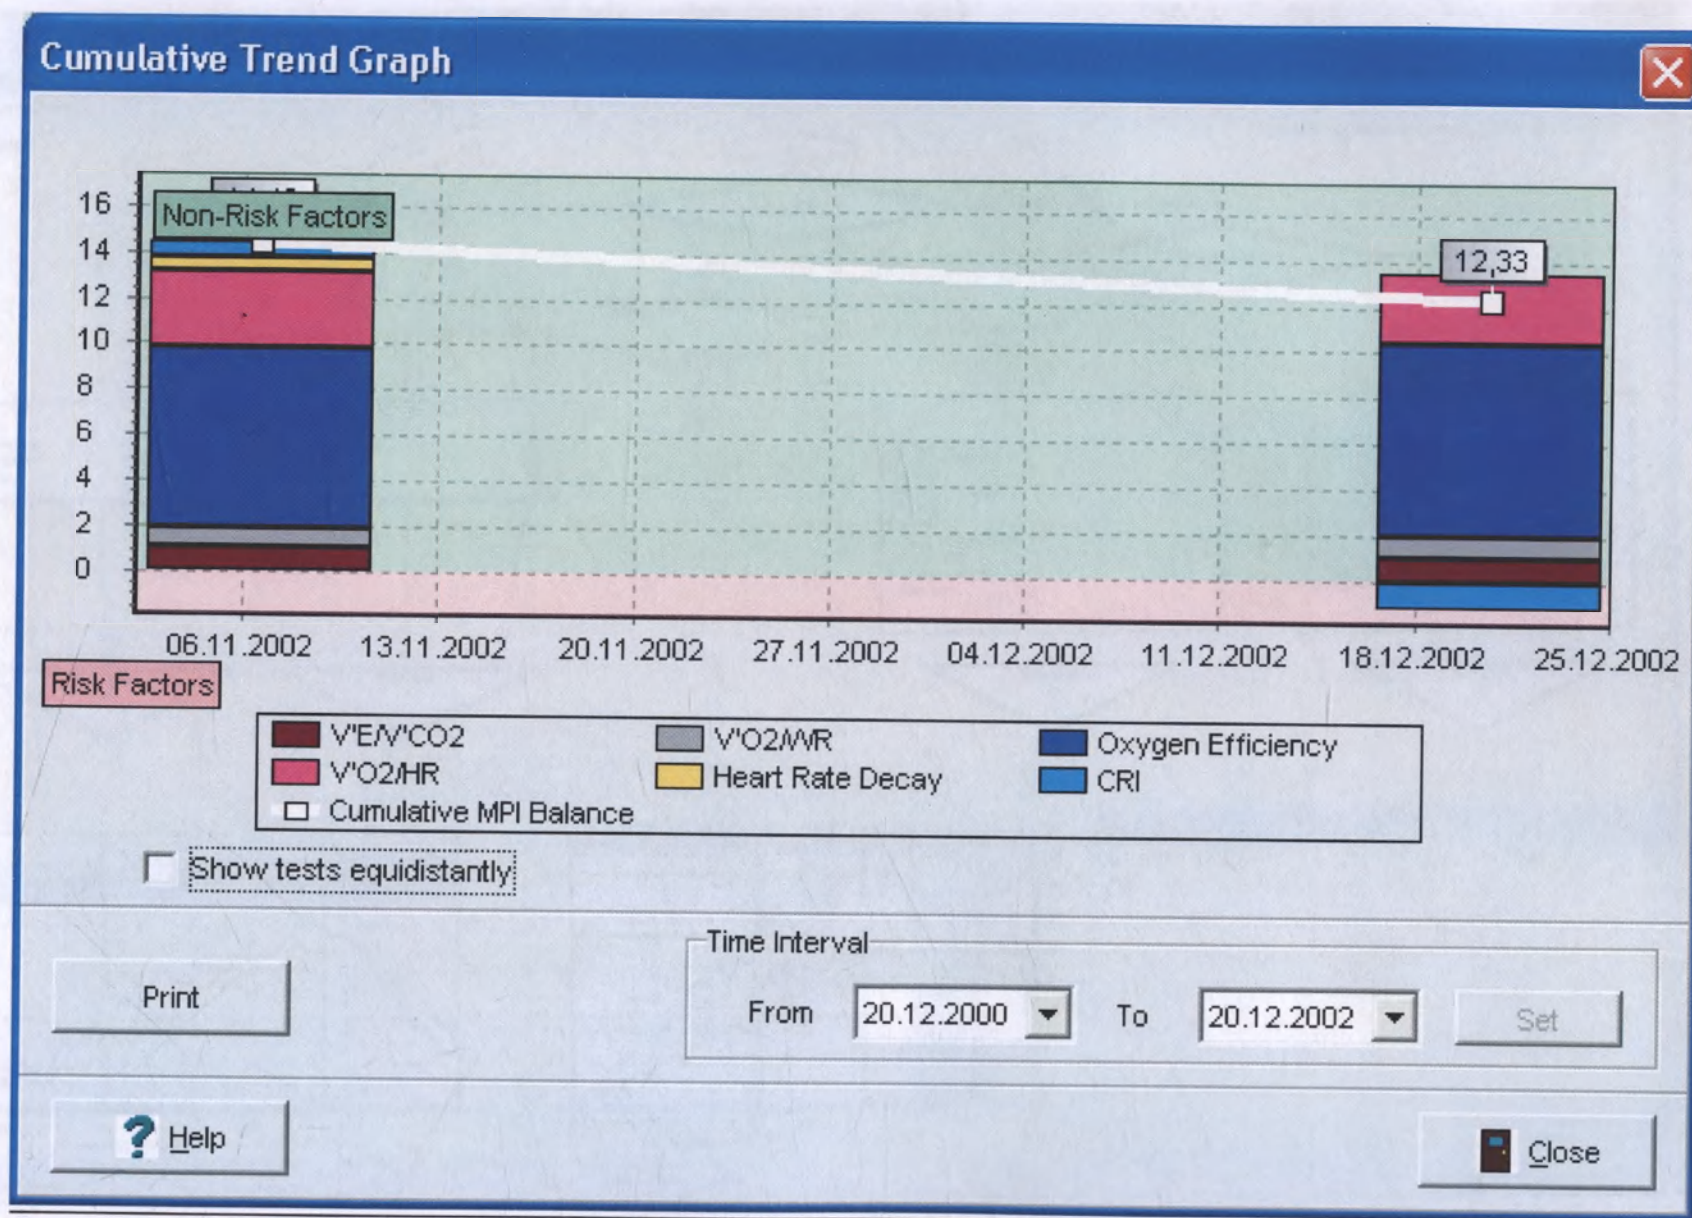


Exercise Schedule

No	Day	Exercise	HR Zone / Exerc. Type	Duration, [min]	W, [kcal]	Remark
1	Monday	Running	Extensive Endurance 143 - 176	30	270	
2	Wednesday	Cycling	Development Zone 175 - 184	30	360	
3	Wednesday	Training Courses	Back Training	45	-	
4	Friday	Running	Extensive Endurance 143 - 176	30	270	
5	Sunday	Cycling	Intensive Endurance 166 - 175	45	450	

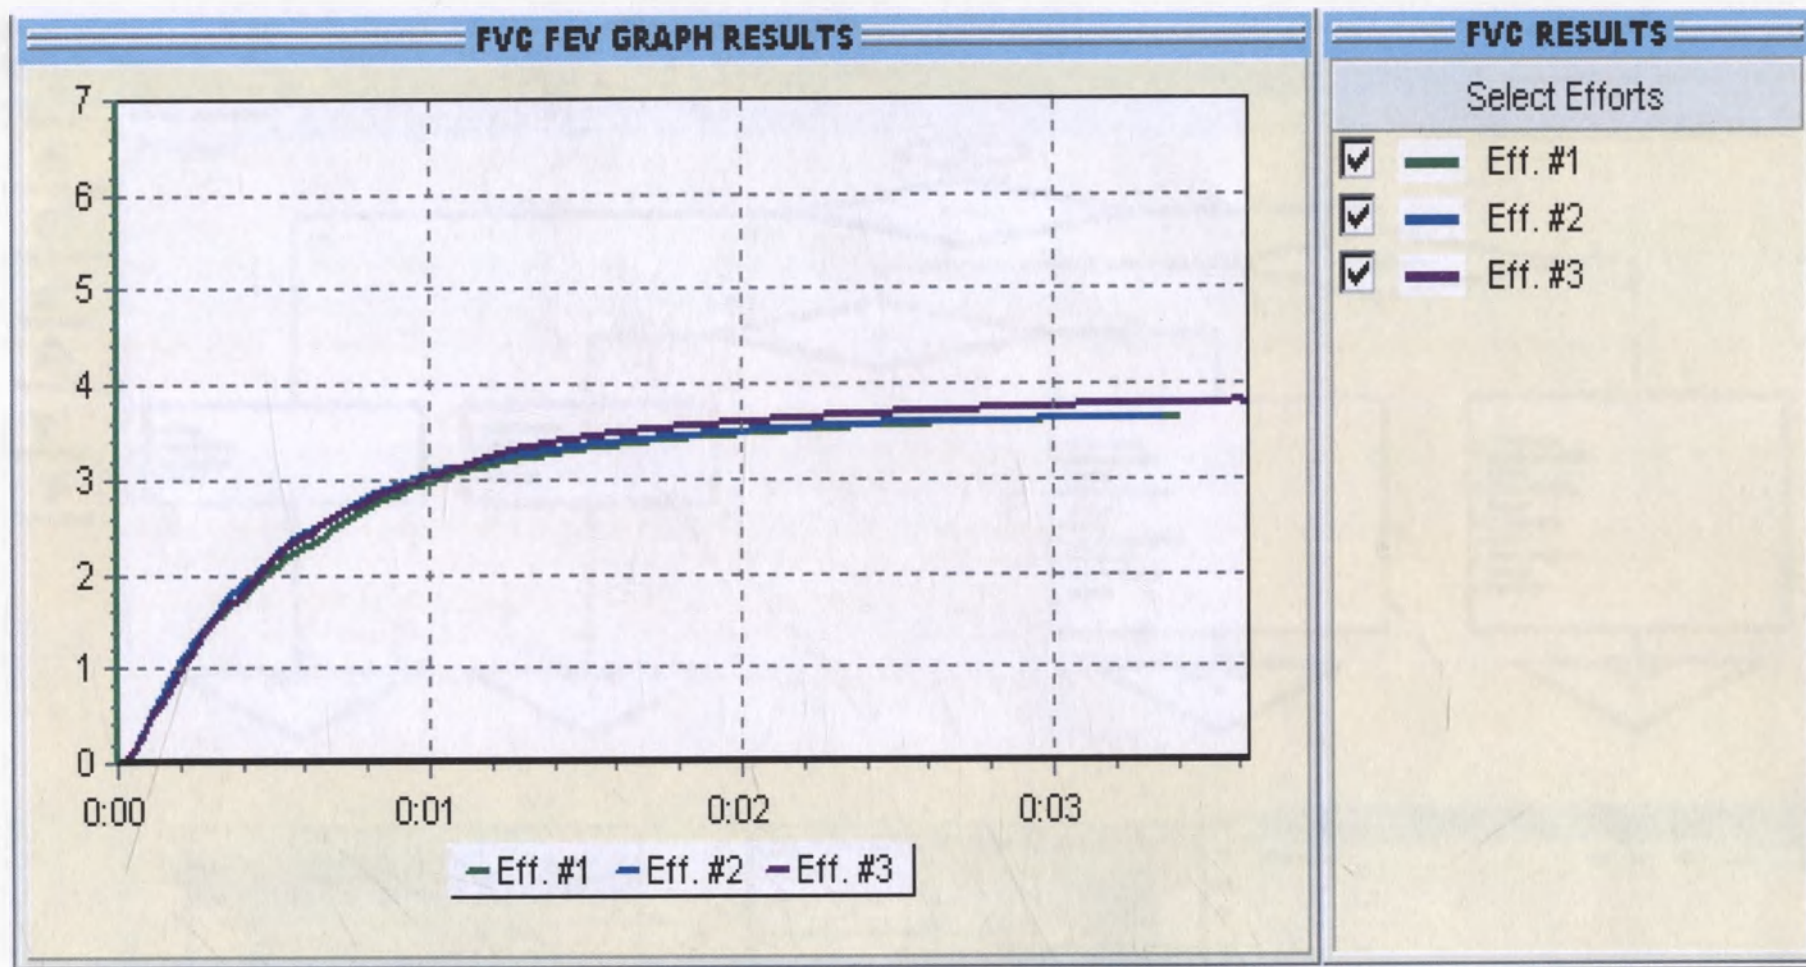

14. Опция программного обеспечения Неинвазивный сердечный выброс на CD-диске:

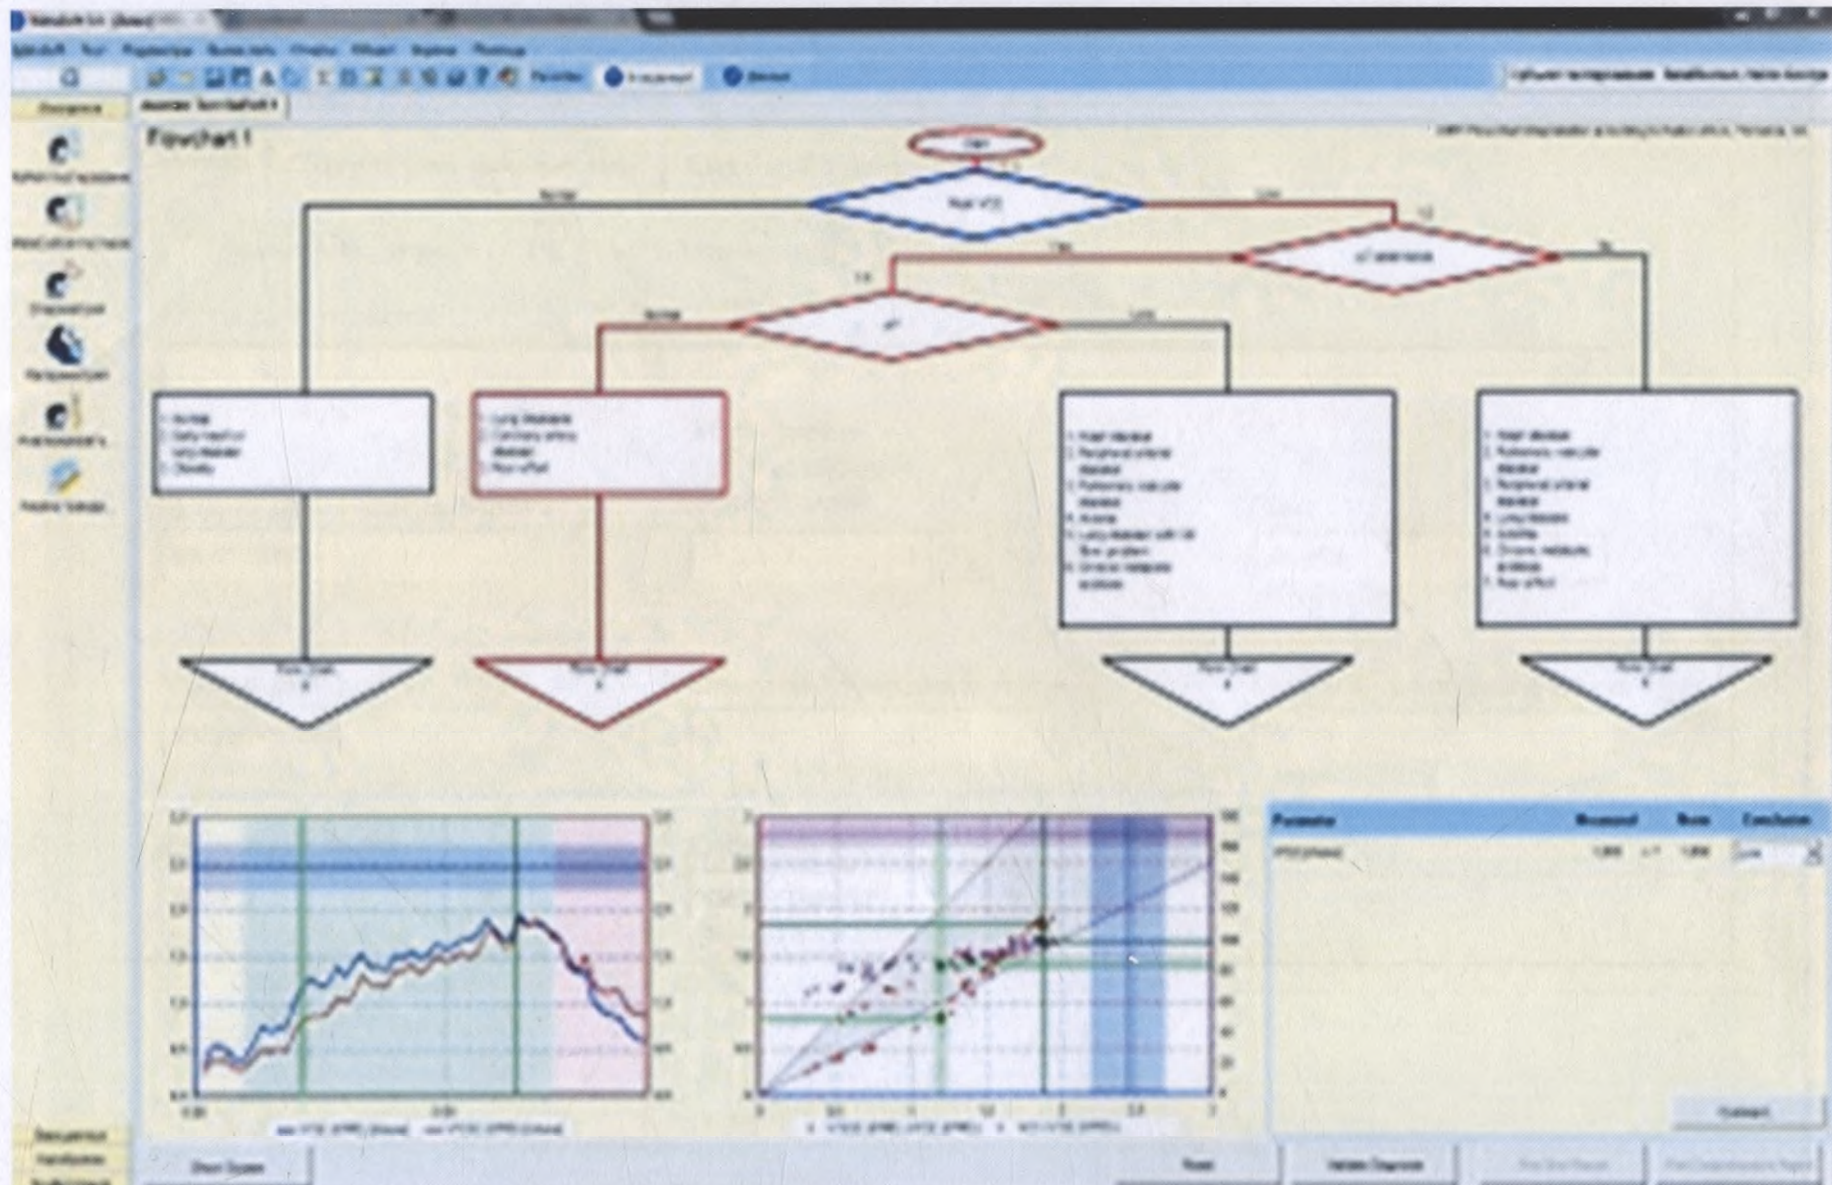

Конфигурировать HL7

☒ Использовать HL7

Общее | Структура сообщения | Export Settings

☐ Automatic Import of HL7-A01-Messages

Путь для поиска

Маска для имени файла

auc*.dat

Интервал
поступающих
сообщений

1 [сек]

Код

ASCII

Маска для даты

yyymmdd

Символ мужского пола

M

Символ женского пола

W

Единица роста

метр

Единица веса

килограмм

Установить по умолчанию

Загрузить настройки по умолчанию

Помощь

ОК

Отмена

16. Набор для калибровки датчиков объема/потока и газоанализатора:






245

18.Стойка мобильная для размещения компонентов системы:




246

19. Крепление системы MetaMax 3В для стойки мобильной:

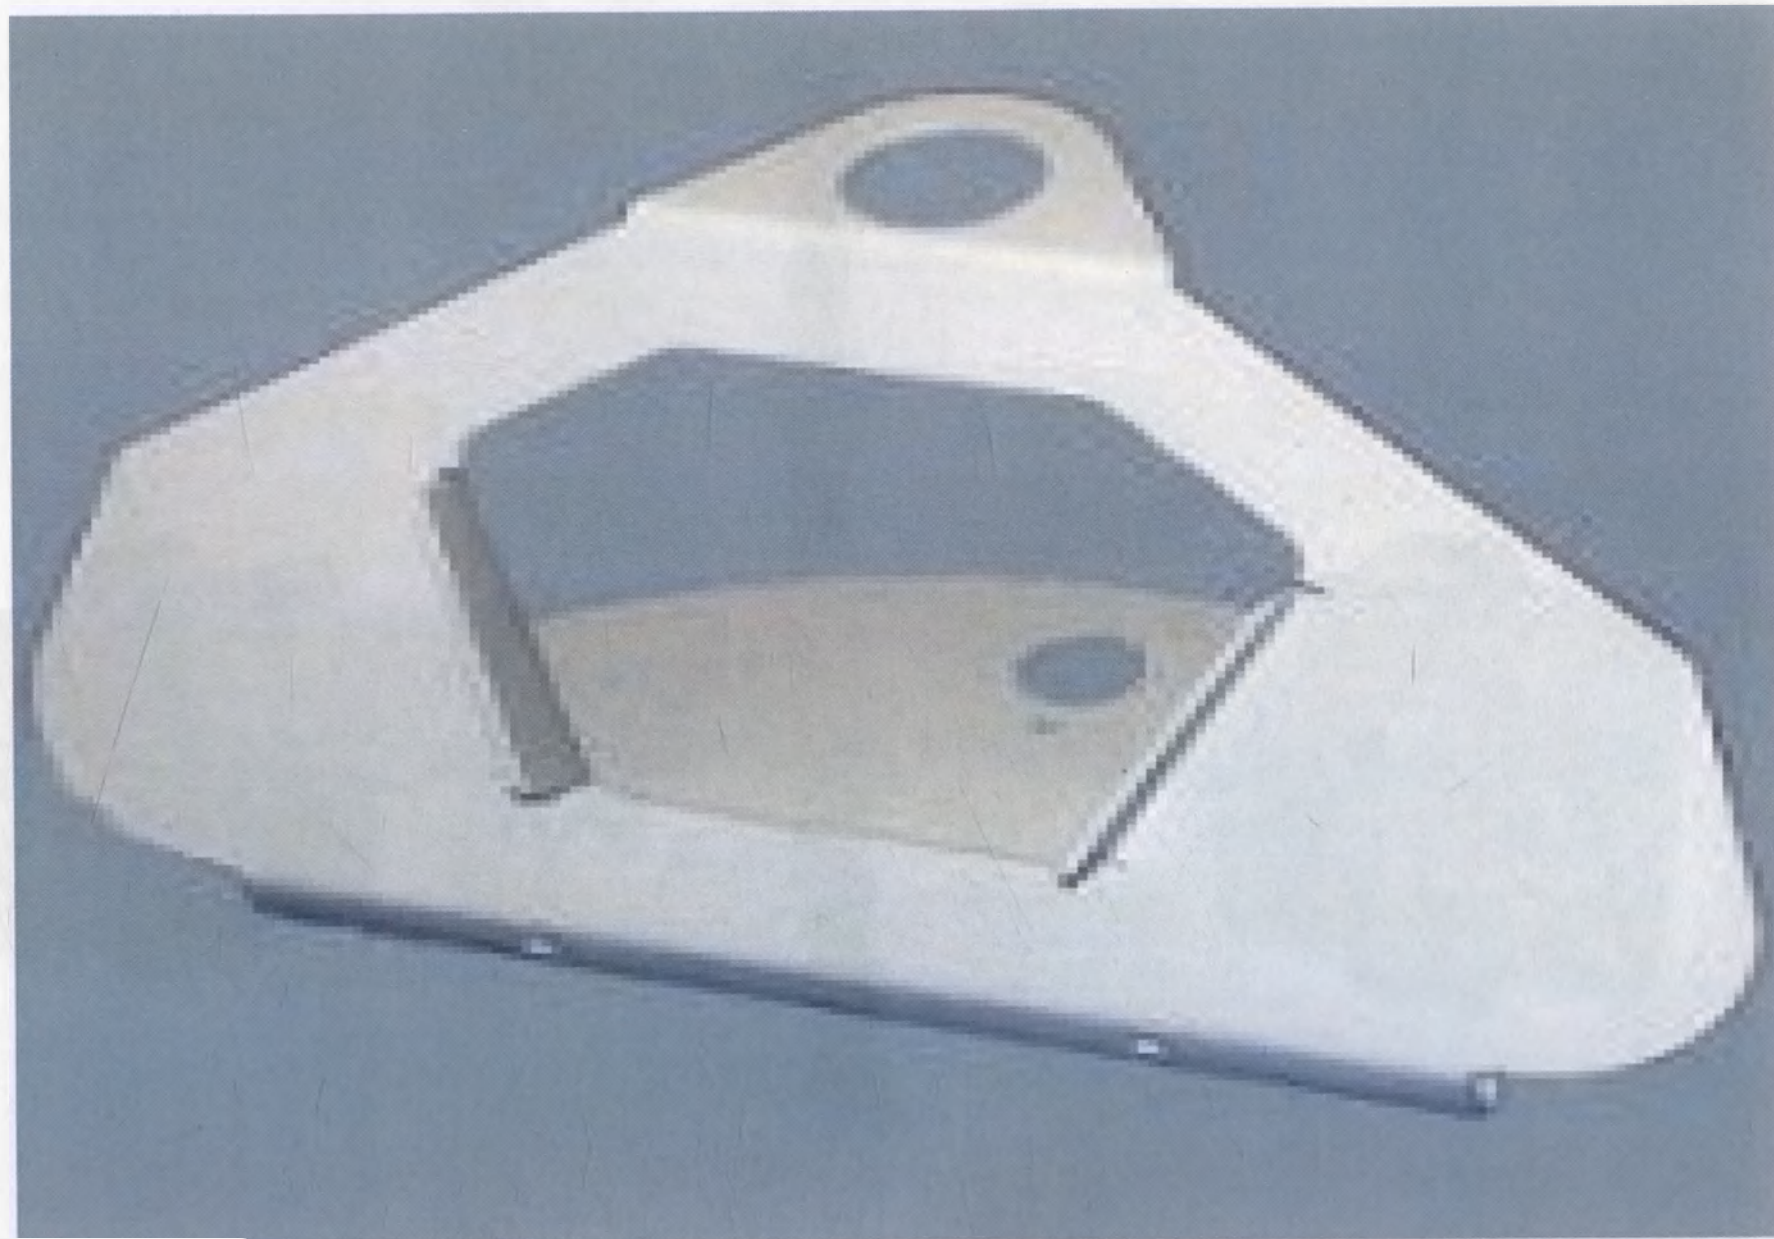


742

20. Крепление для мониторов:

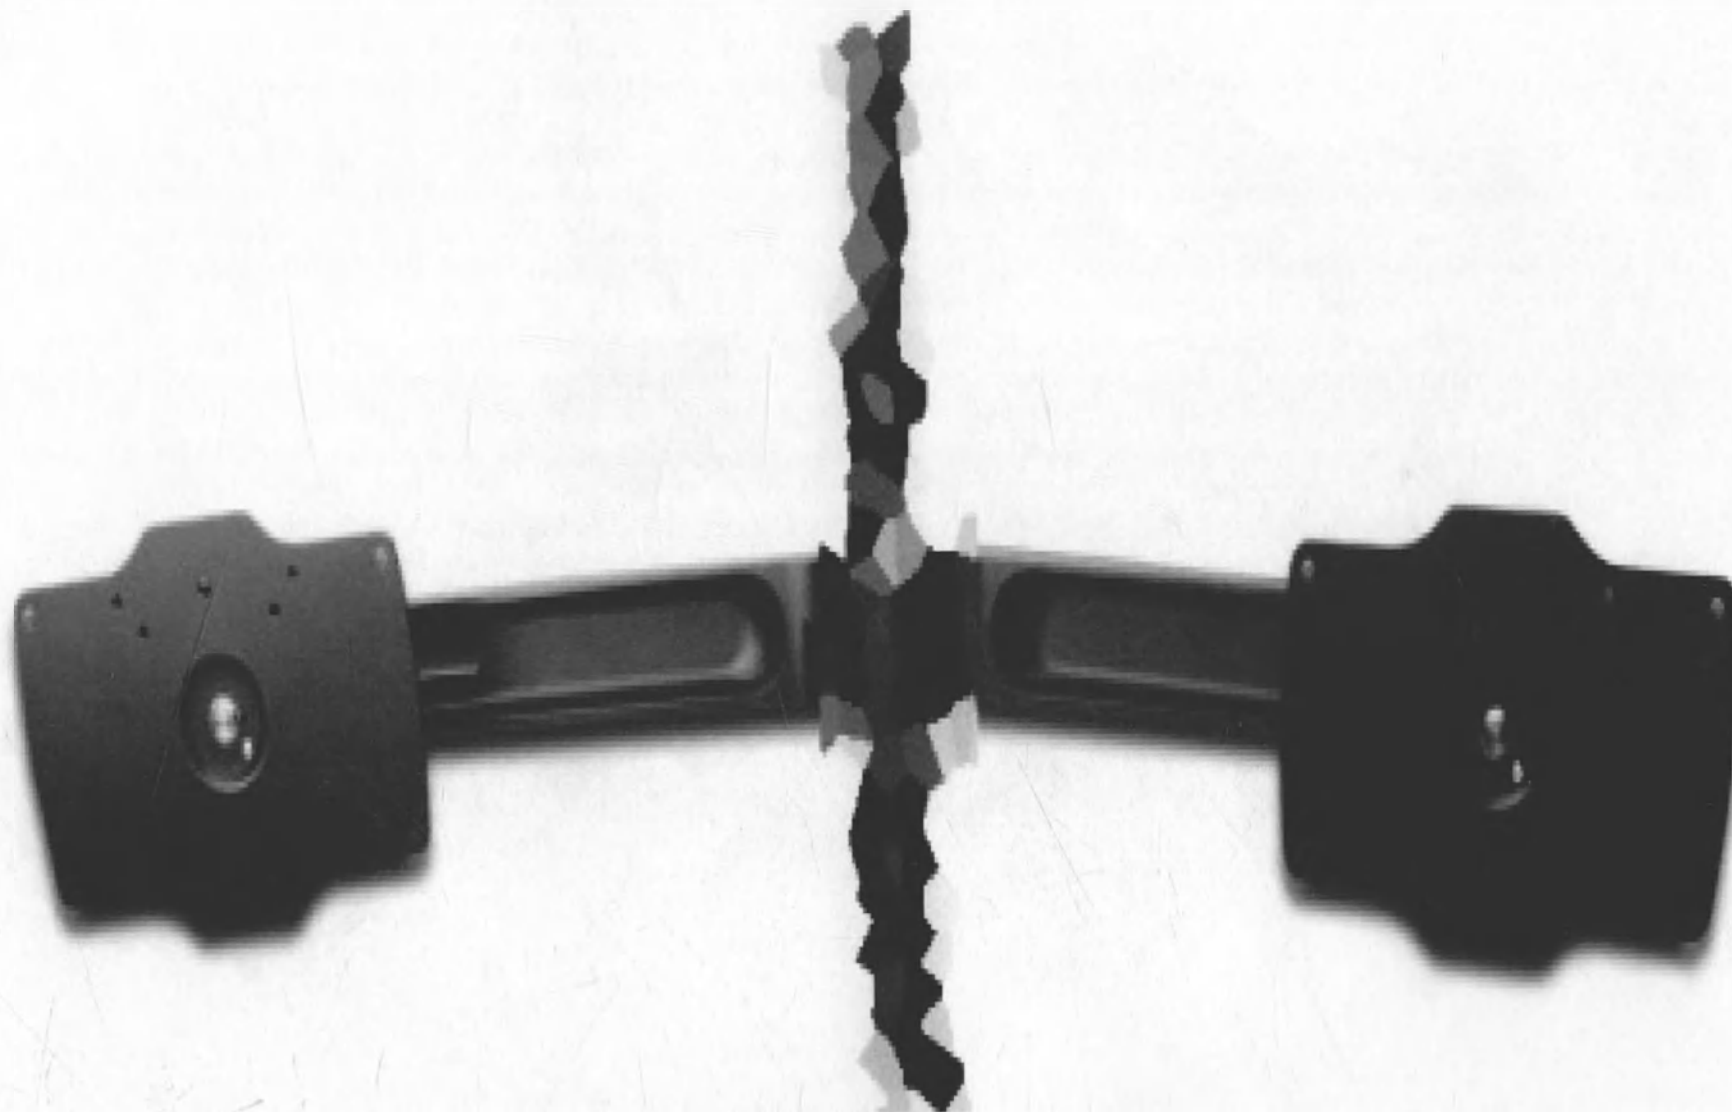

248

21. Ручка поддерживающая:

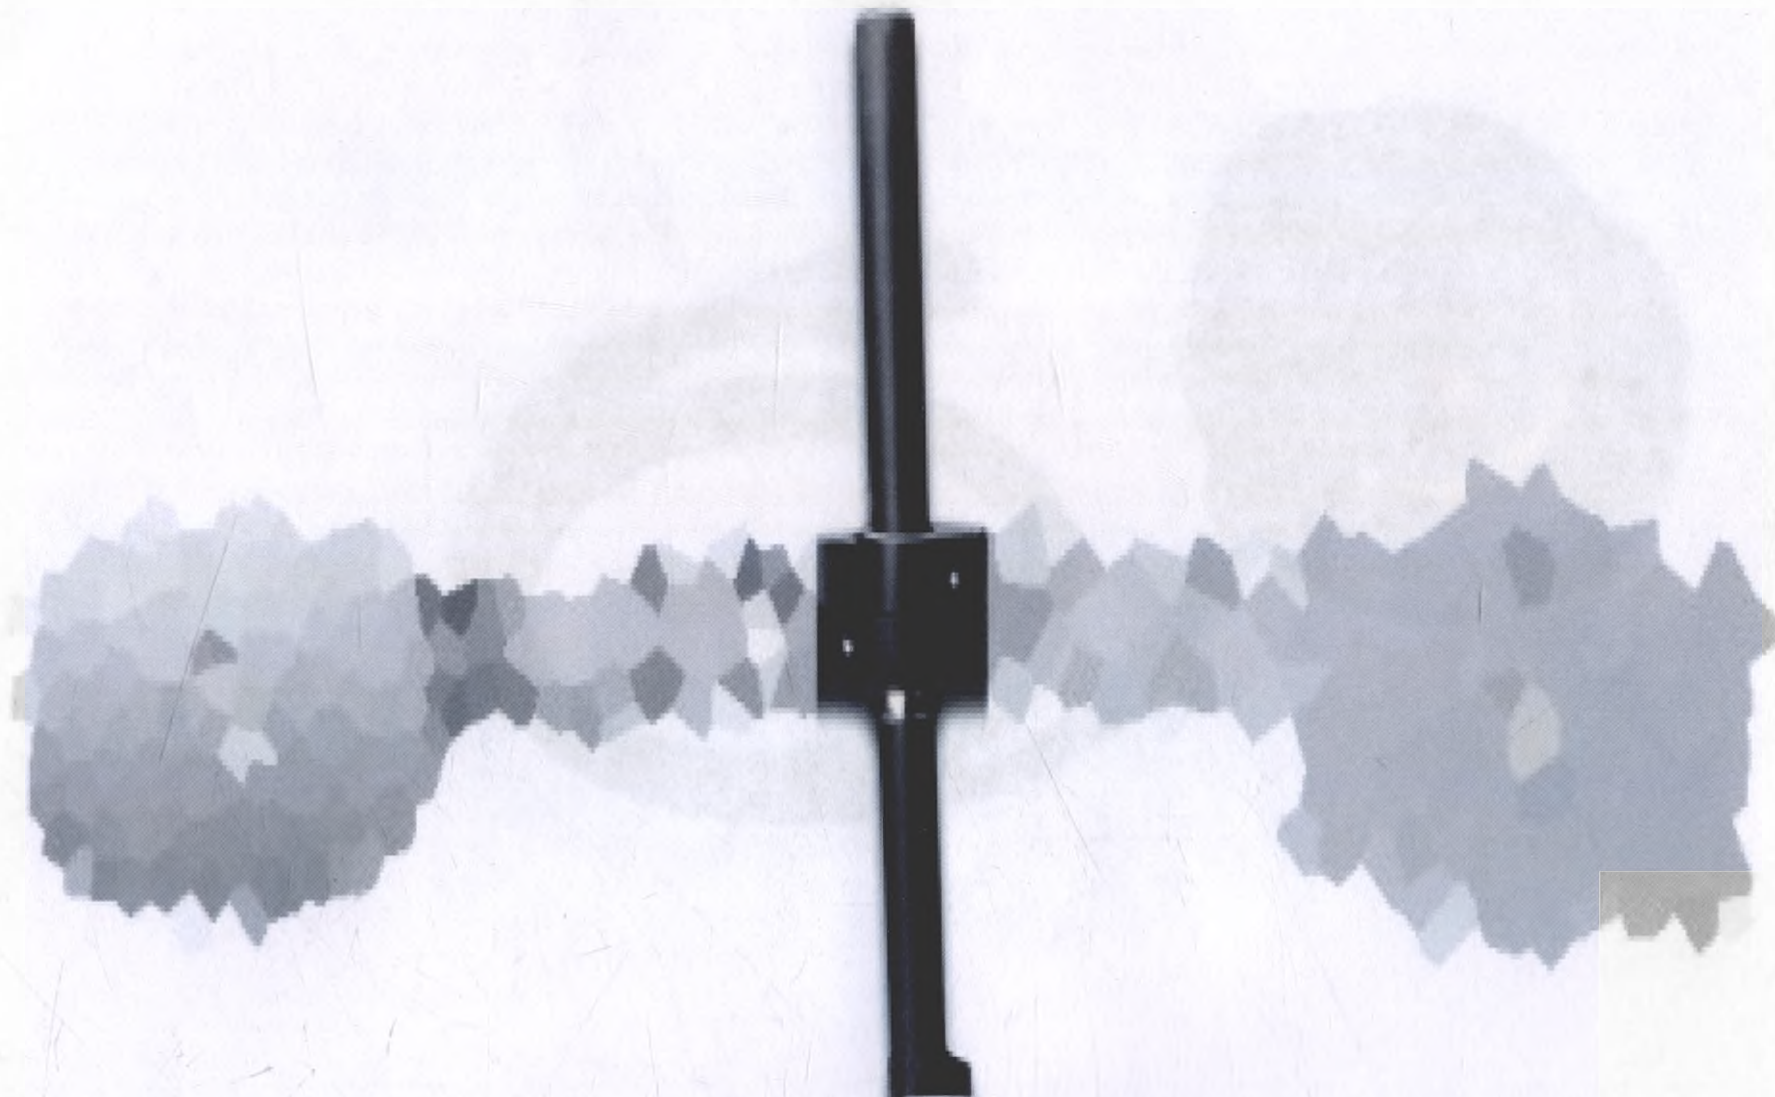

6m2

22. Датчики объема/потока со встроенным температурным сенсором длиной 2 м:



250

23.Датчики объема/потока со встроенным температурным сенсором, длиной 0,6 м:




192

24. Крышка ветрозащитная датчика объема/потока:



252

25.Линии отбора пробы газа, длиной 0,6 м:

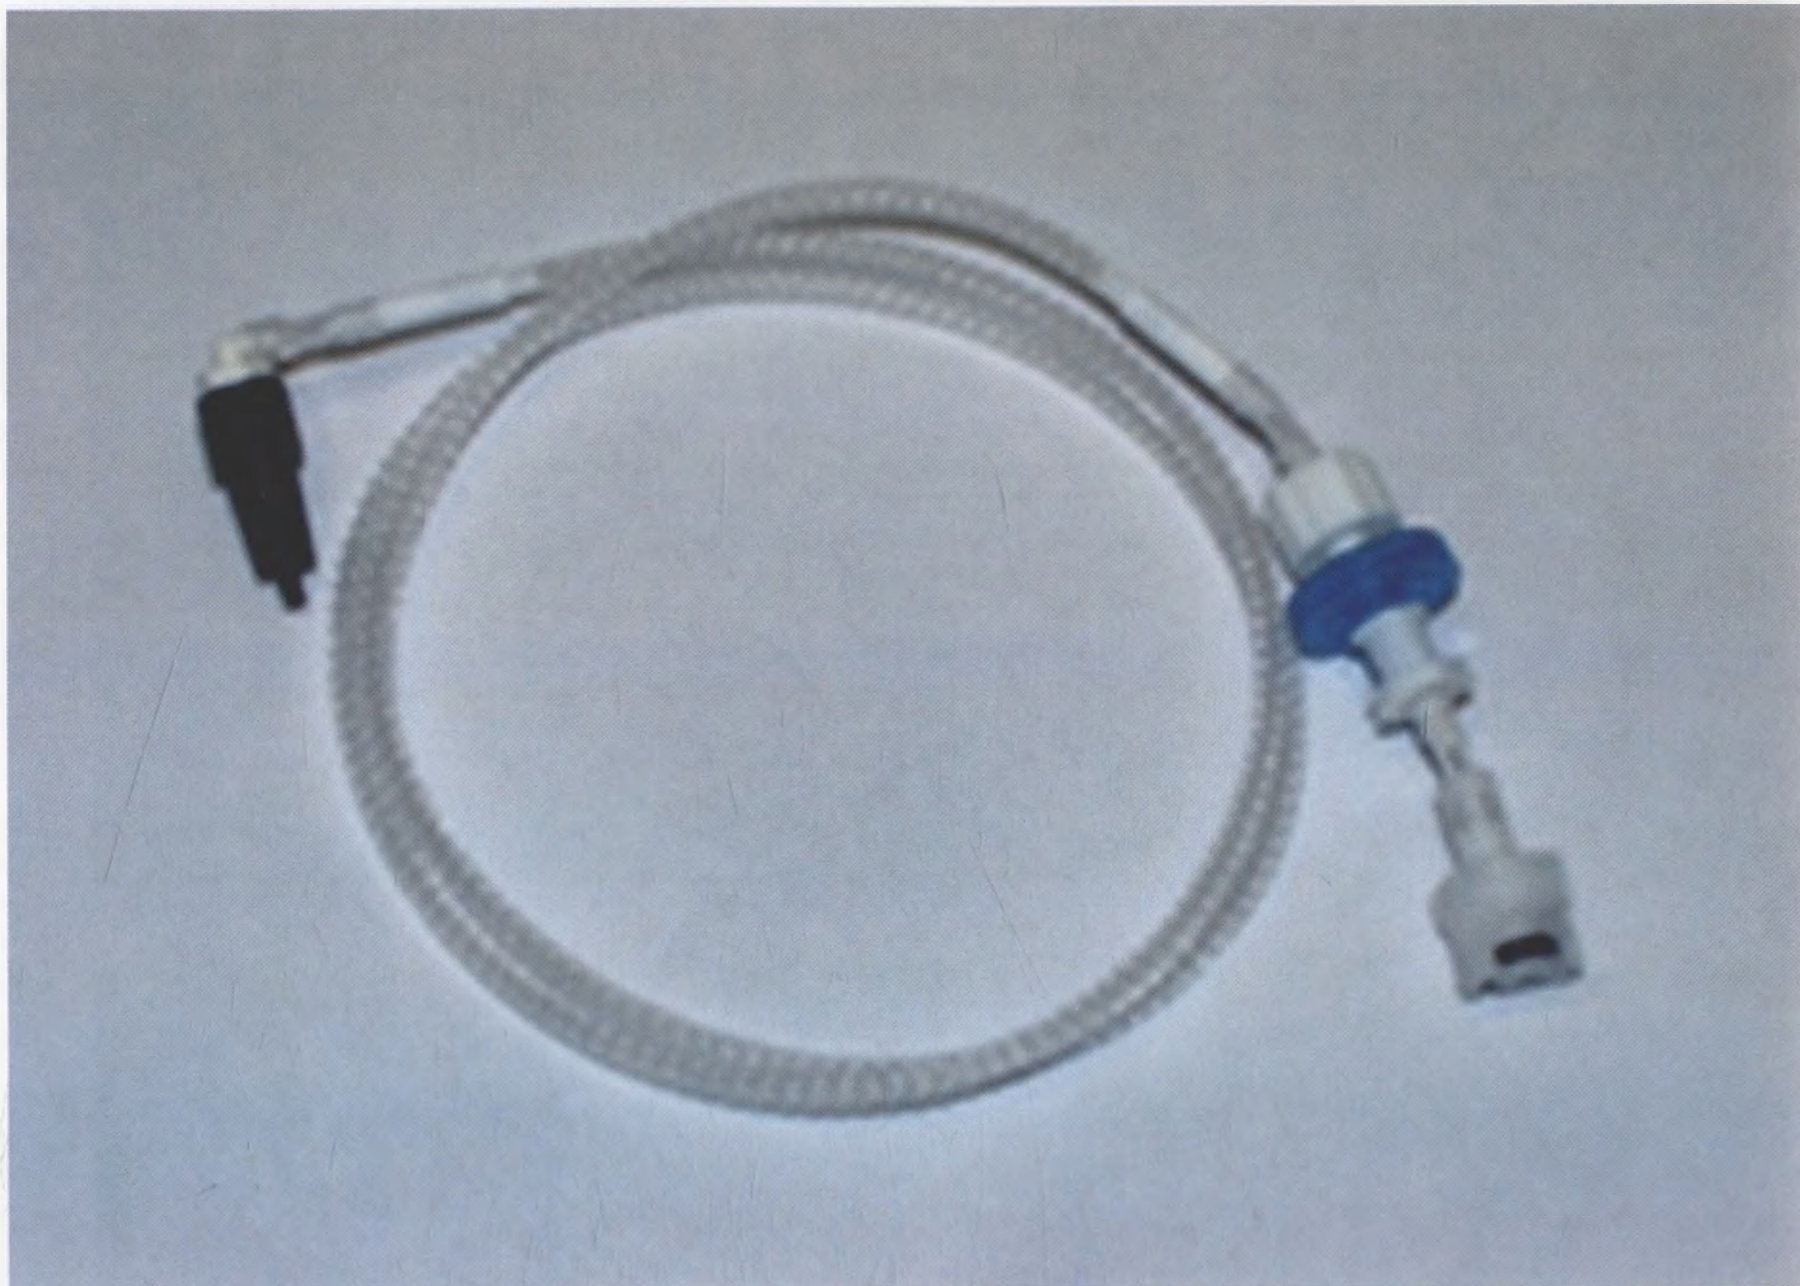

252

26.Линии отбора пробы газа, длиной 2 м:





27. Маски лицевые детские:

28. Маски лицевые размера XS:

29. Маски лицевые размера S:

30. Маски лицевые размера M:

31. Маски лицевые размера L:

450

32. Адаптеры для лицевых масок:




33.Крепления для лицевых масок размера S или M:



452

34.Крепления для лицевой маски размера L:

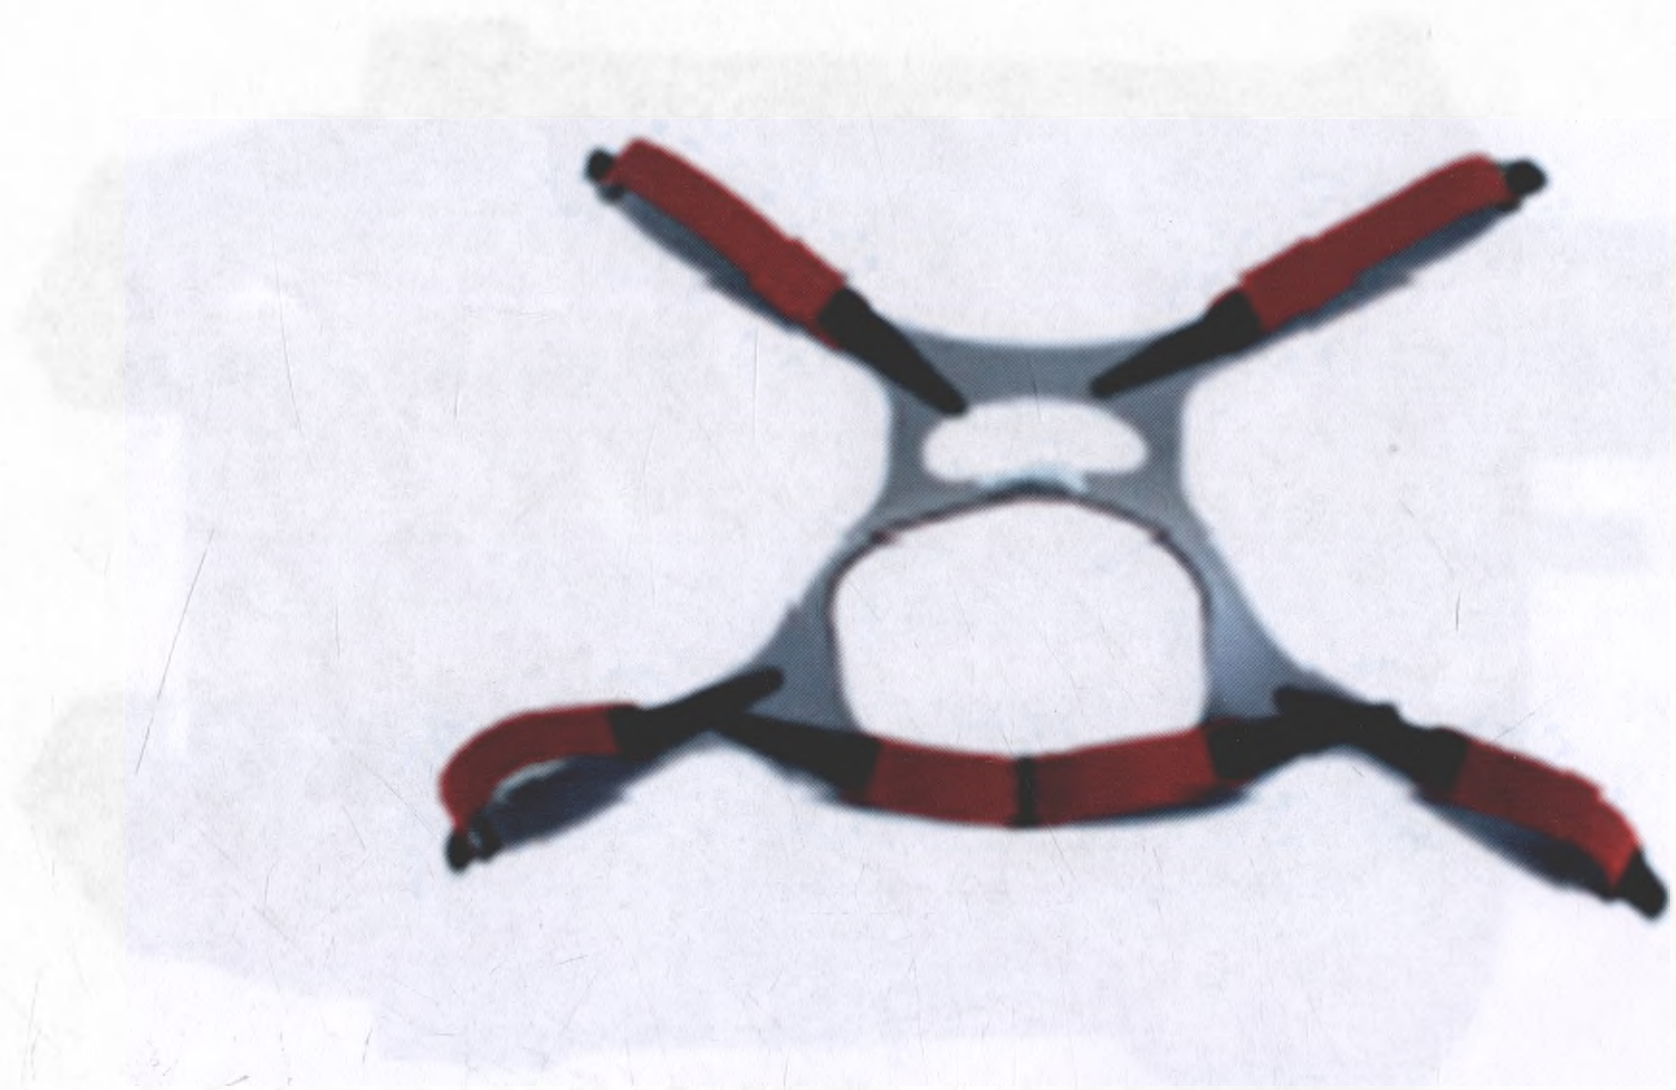





260

37.Баллоны с калибровочным газом, объемом 1 л:



103




262
39. Датчики опто-электронные с кабелем и сенсором температуры для датчика объема/потока длиной 0,6 м:




40. Датчики опто-электронный с кабелем и сенсором температуры для датчика объема/потока длиной 2 м:



41. Датчики пульсоксиметрические с креплением на палец:

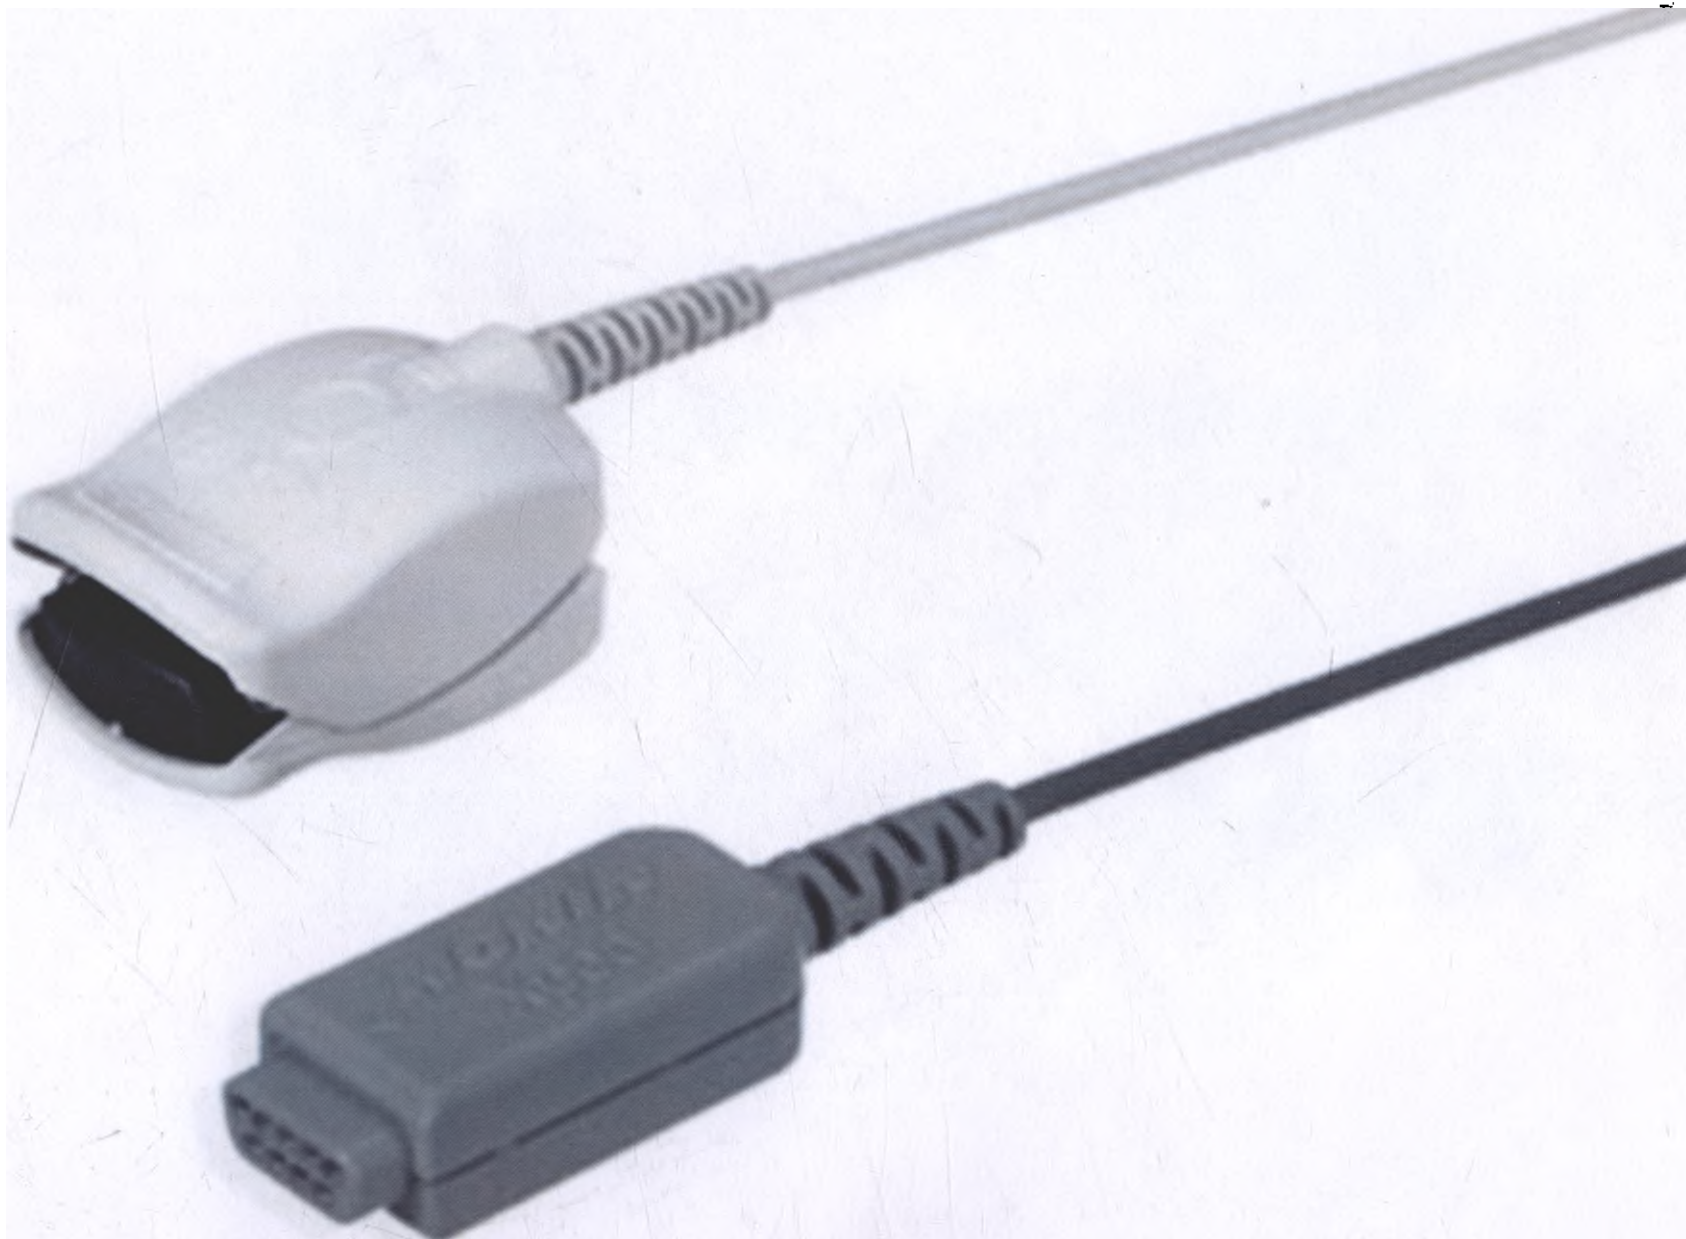

42. Датчики пульсоксиметрические с креплением на ухо:

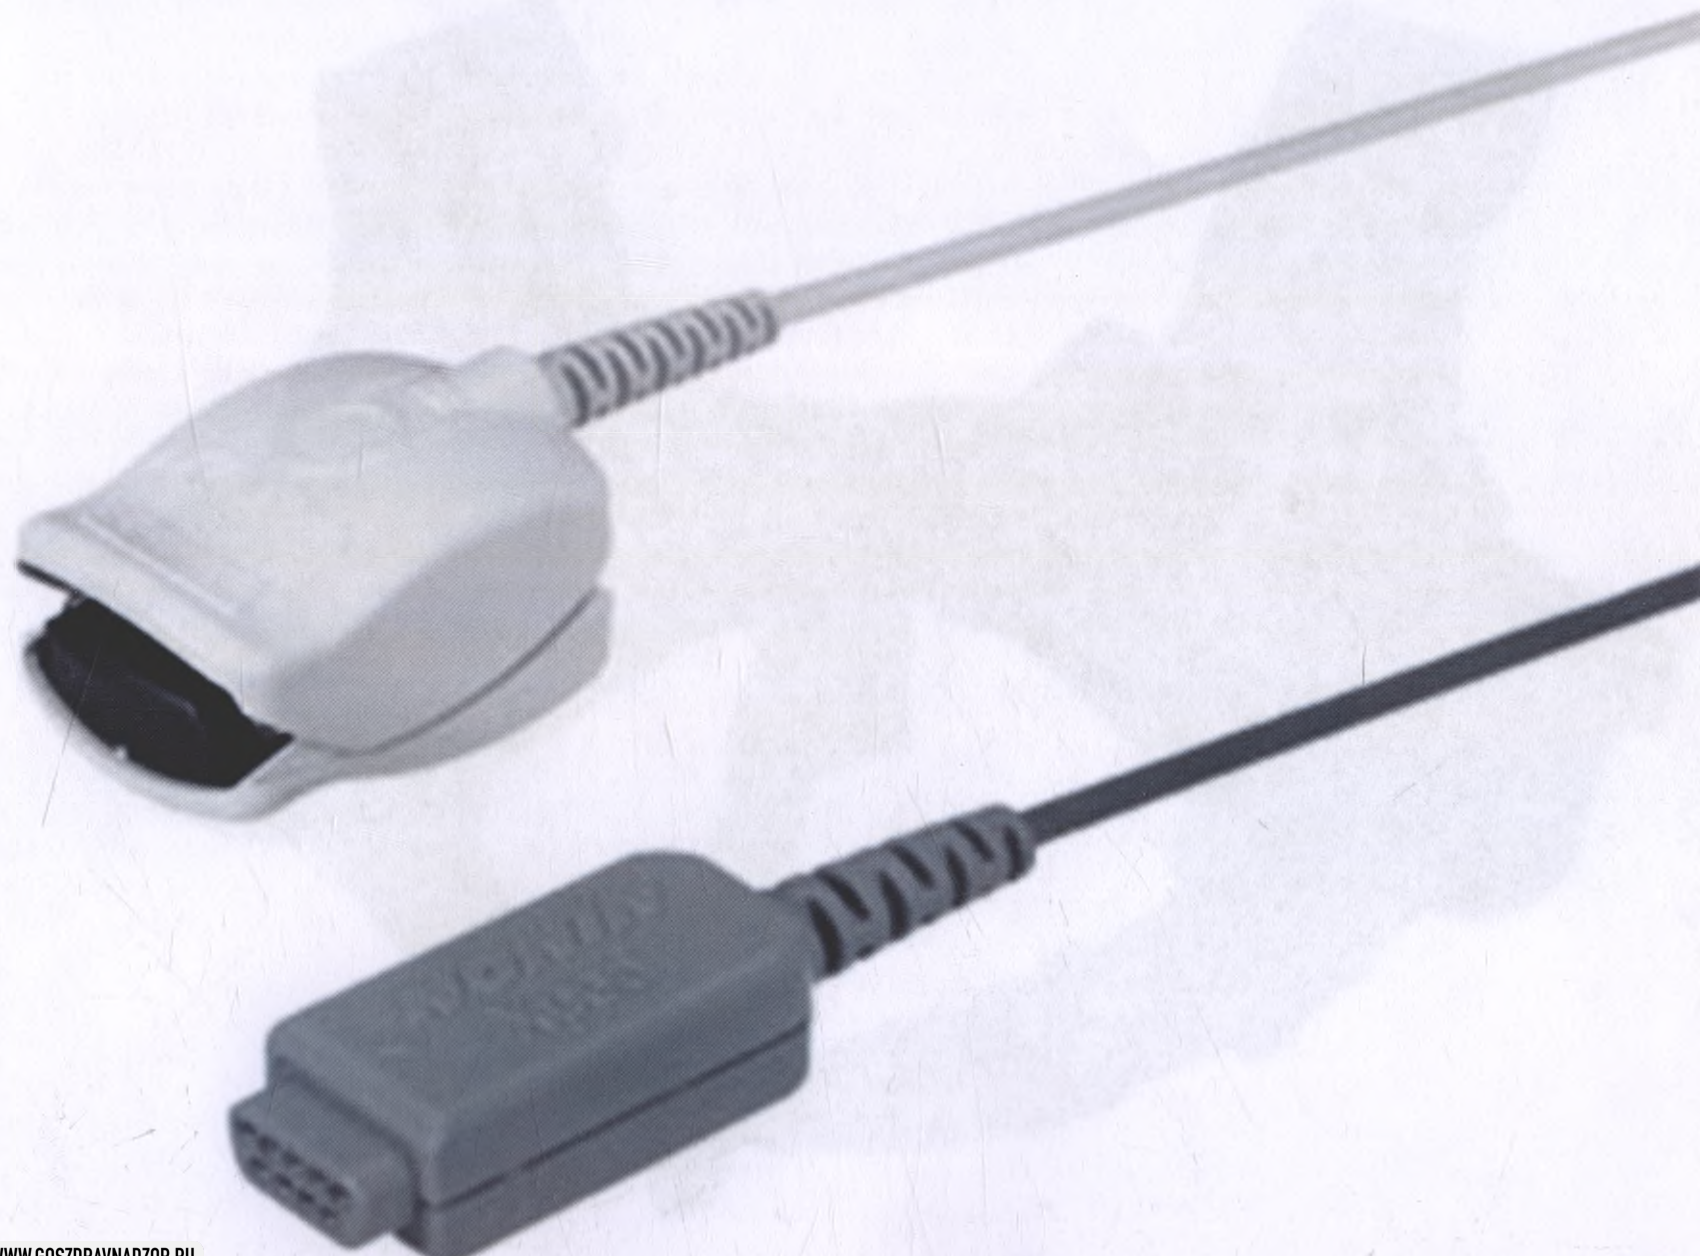

43. Крепления плечевые на грудь, размера S, M:




492

44.Крепления плечевые на спину:




45. GPS-расширение для системы MetaMax 3В:

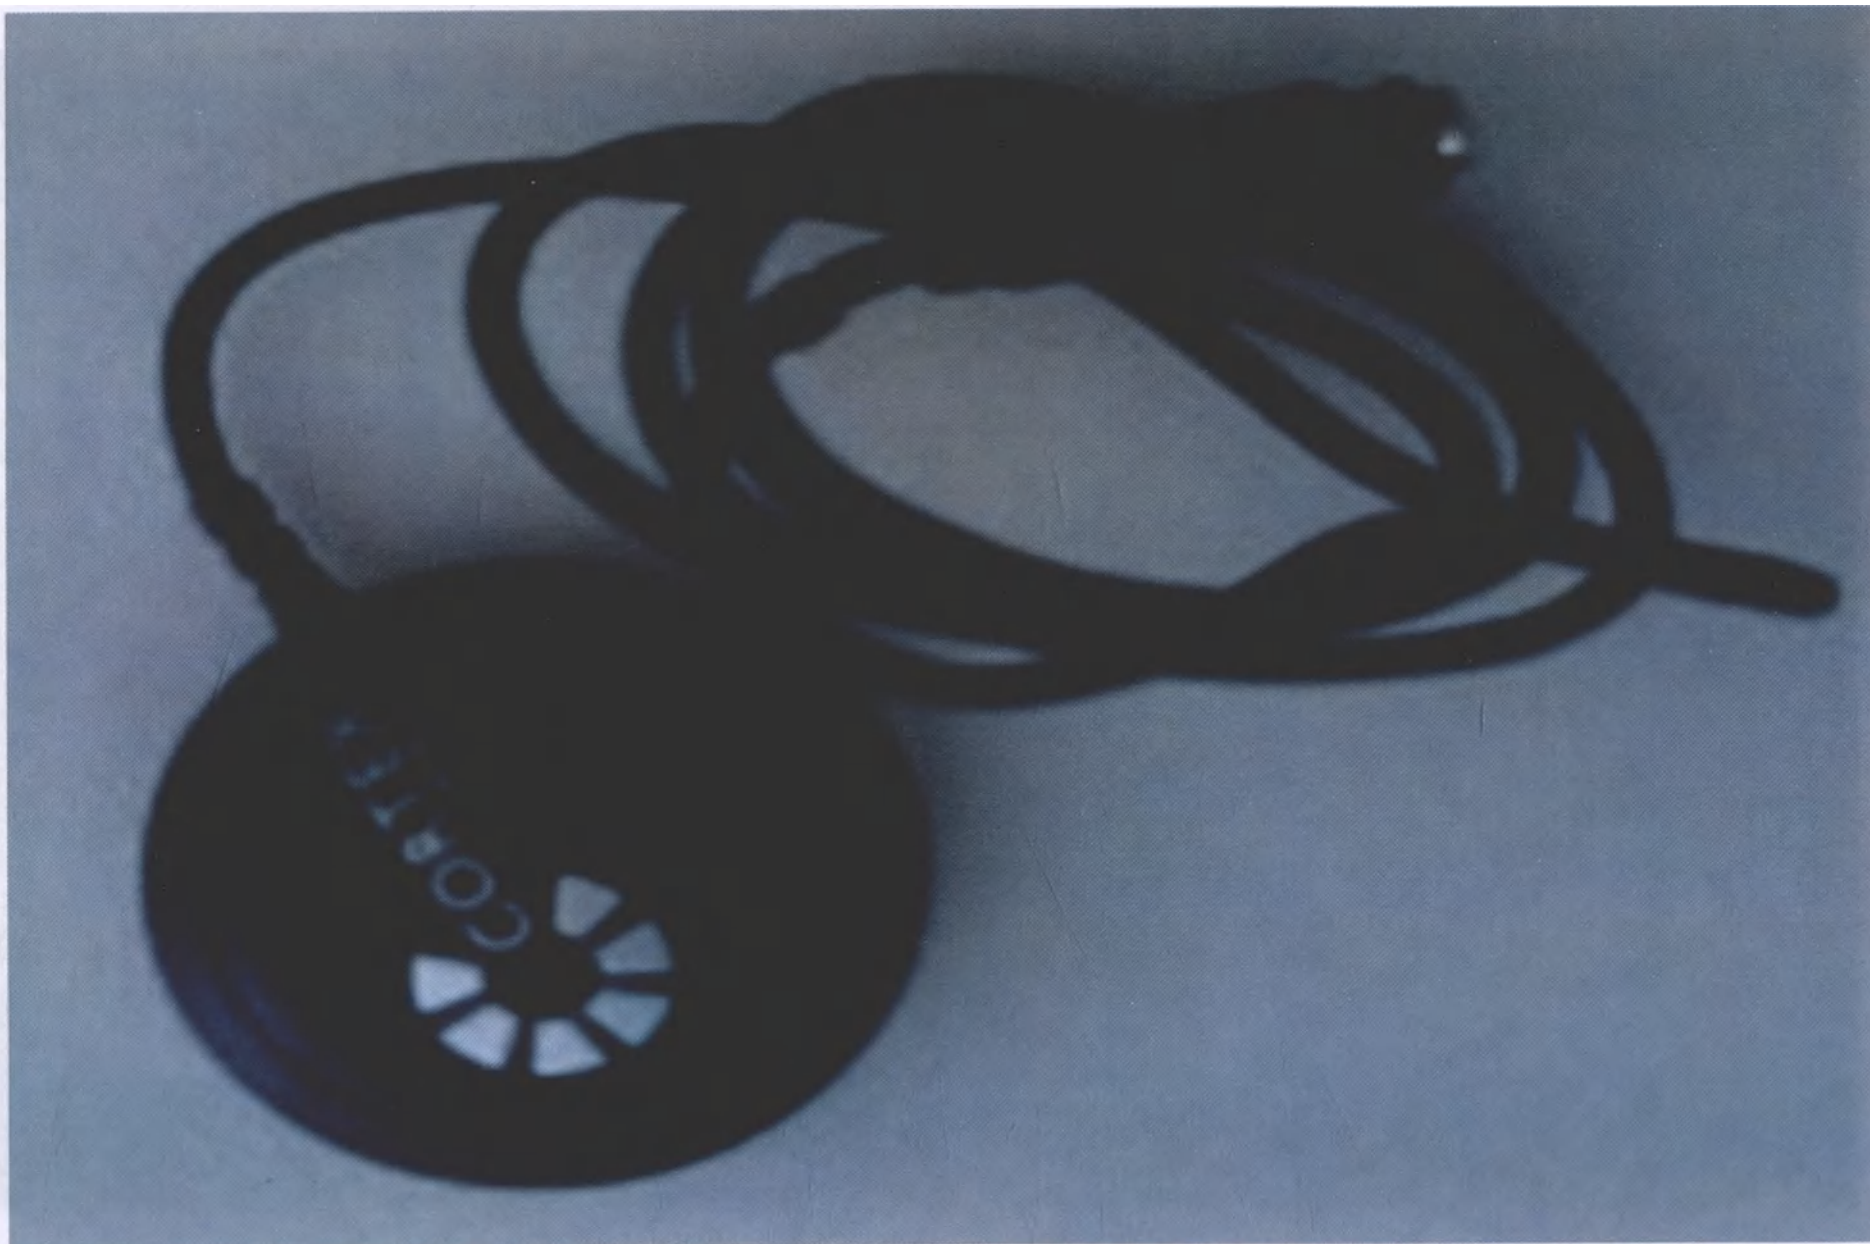

2023

46.Набор принадлежностей для прямого подключения системы MetaMax 3В к компьютеру:

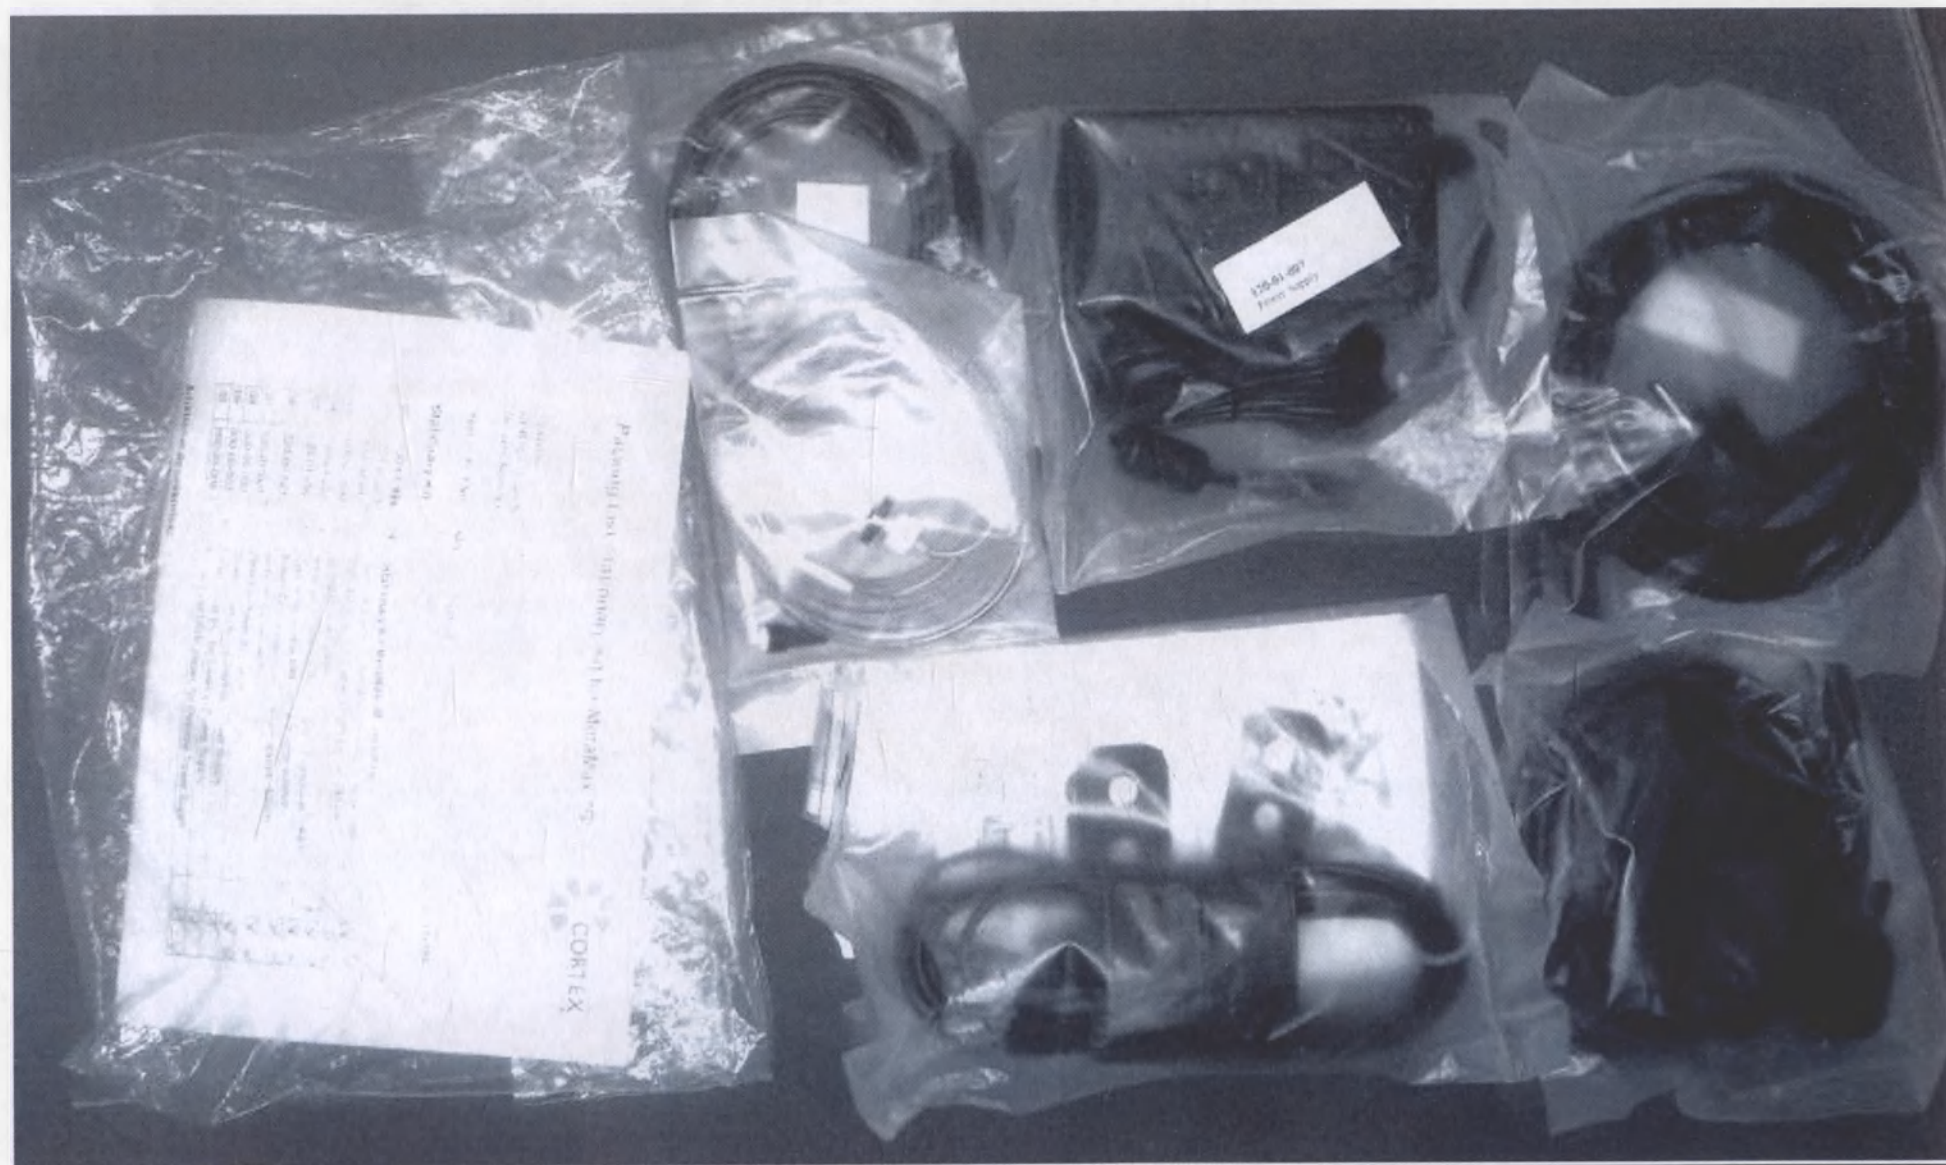

272


- линия отбора пробы, длиной 2 м;




НЗ
- удлинитель для датчика частоты сердечного ритма;



- удлинитель для датчика объема/потока;

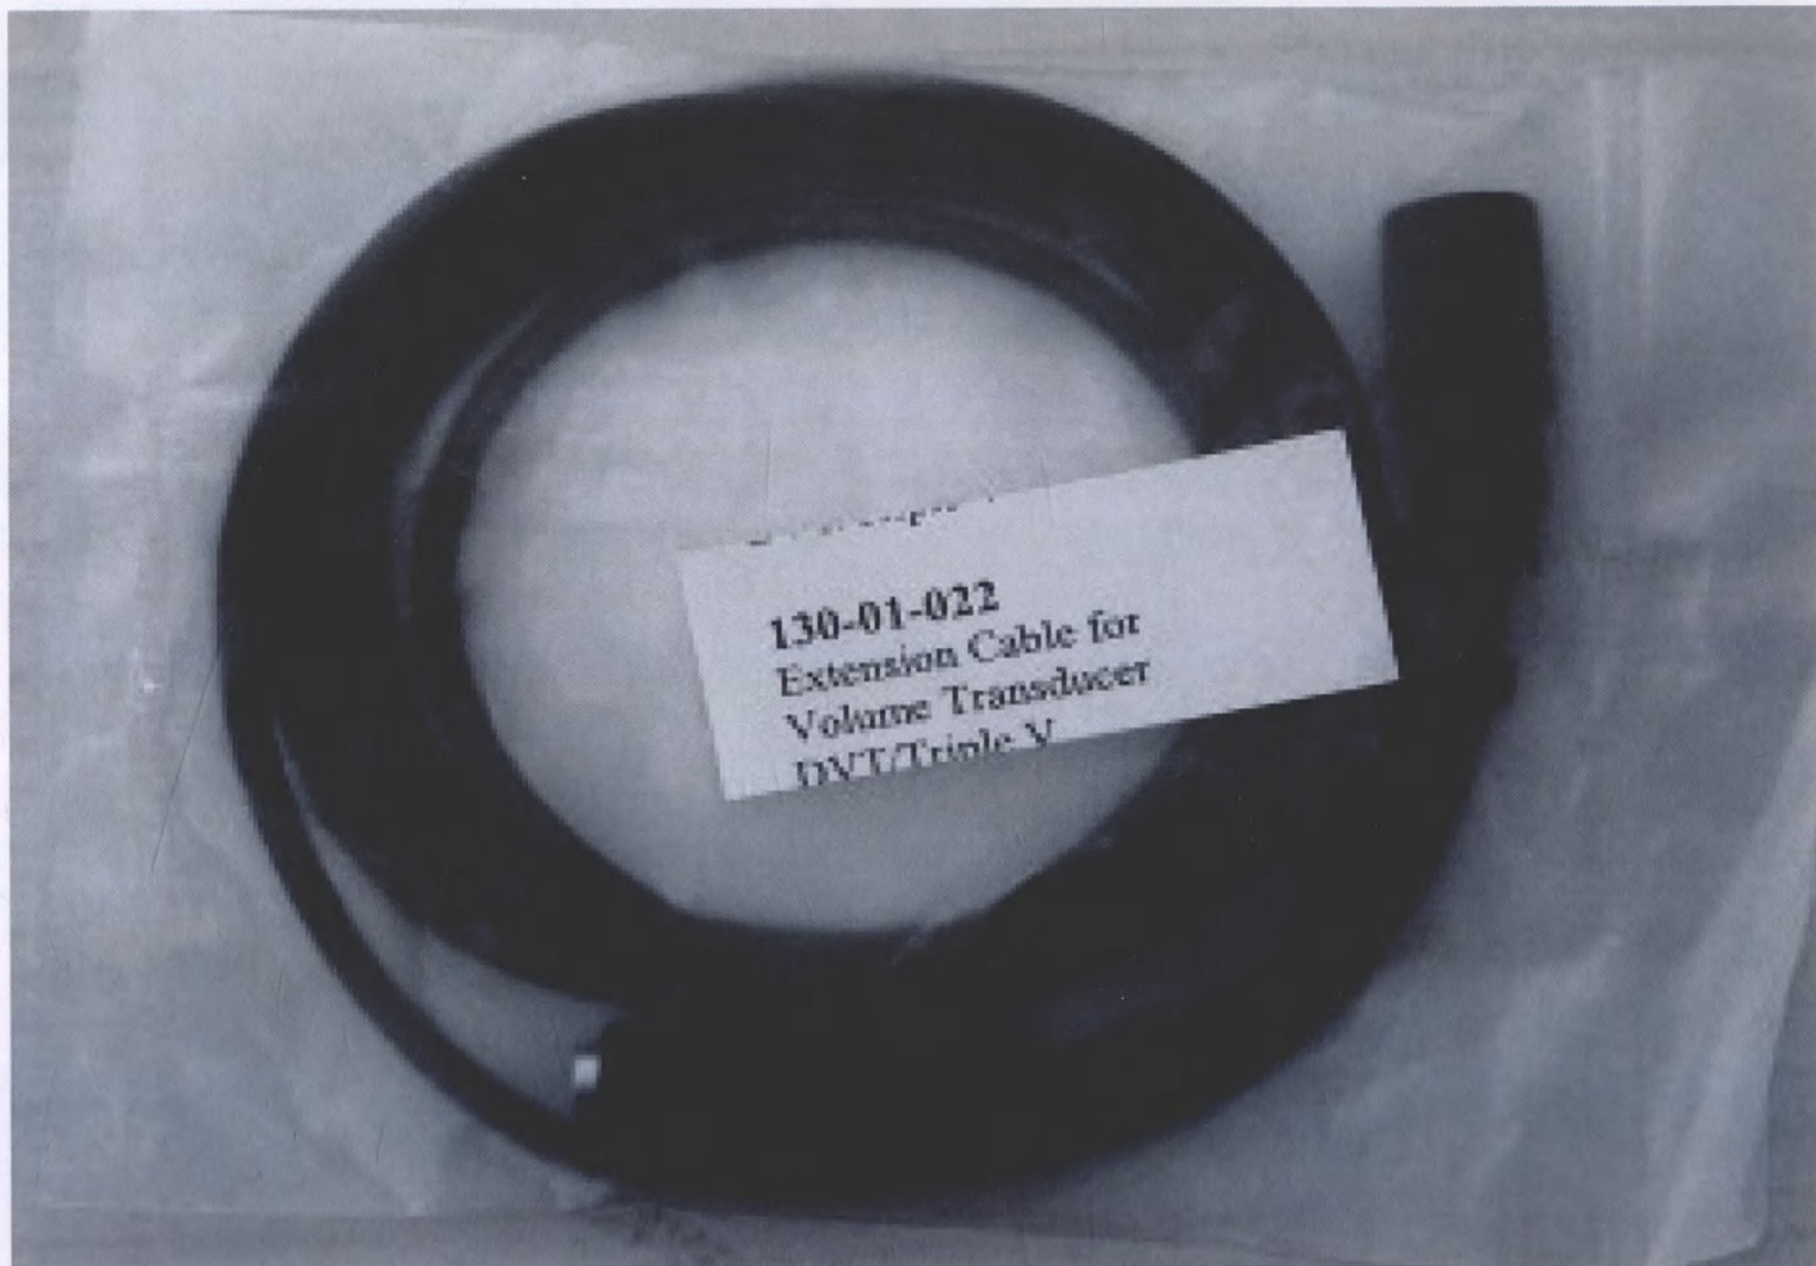

243
- кабель соединительный с Персональным Компьютером.

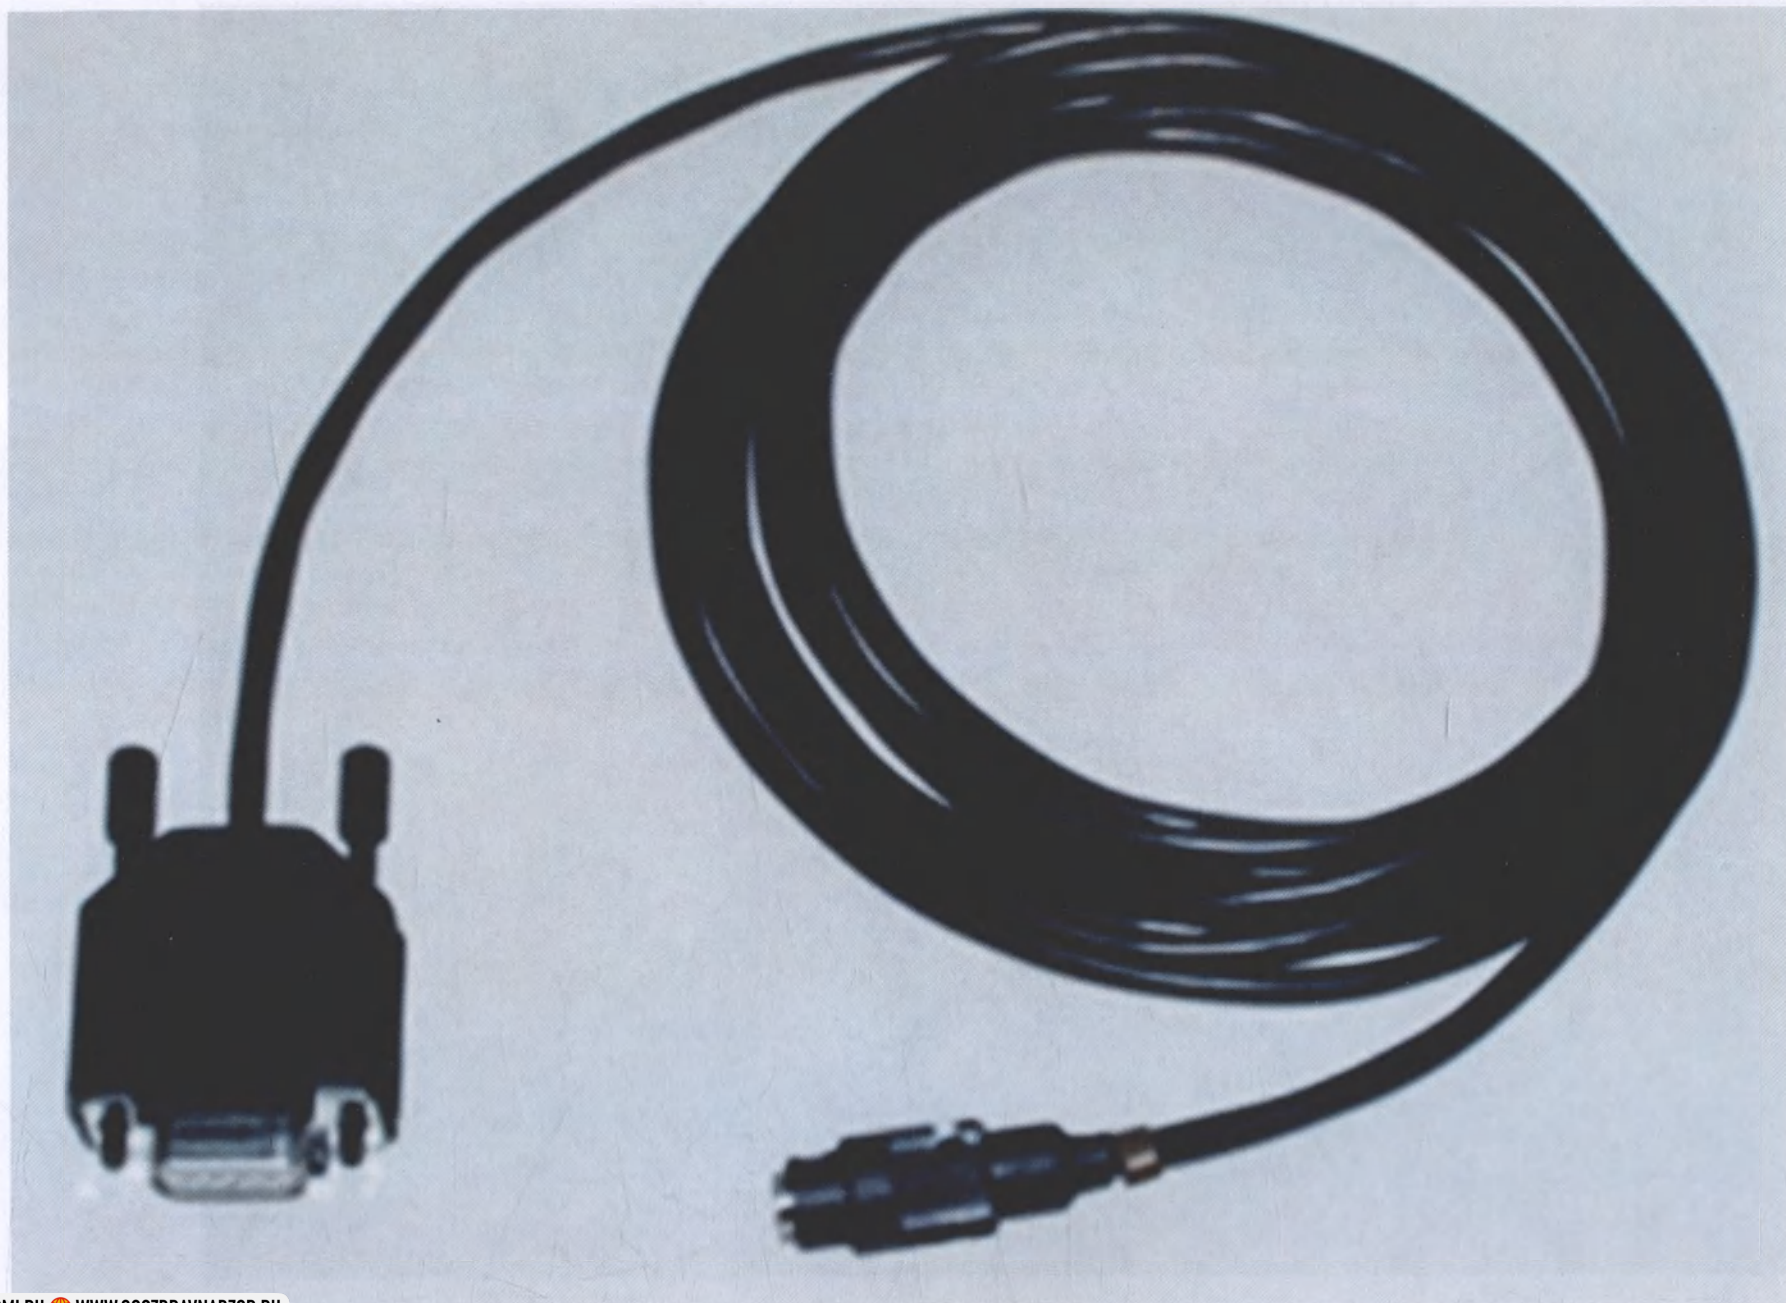



48. Датчики объема/потока для дыхательной трубки:



276

49. Конусы пластиковые для защиты от брызг датчика объема/потока:






51.Трубки дыхательные для классического стиля:




279




53.Модуль приемный для датчика частоты сердечного ритма с кабелем:

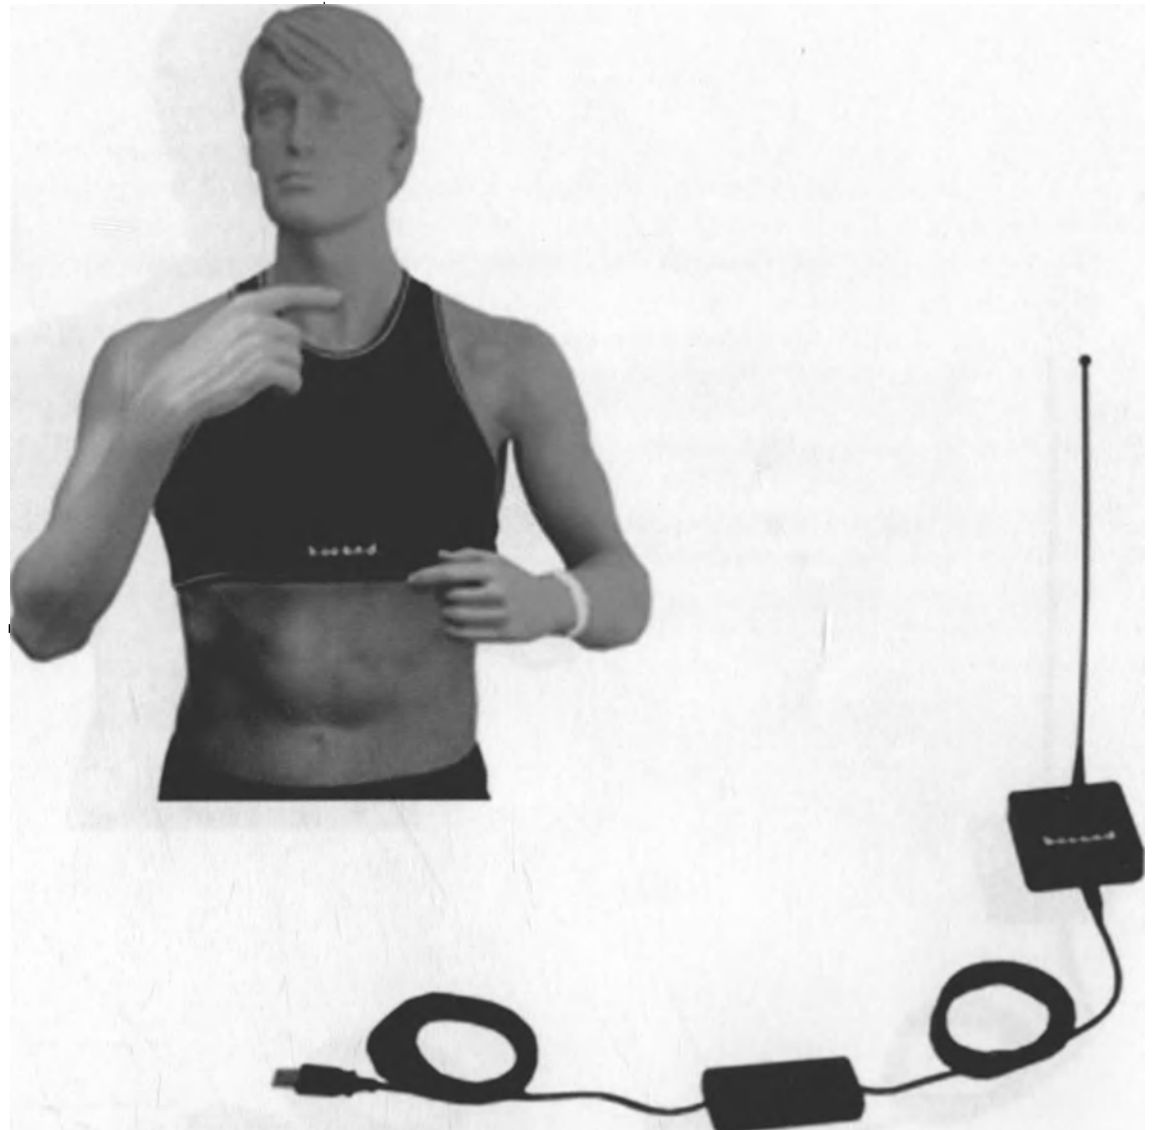


54. Жилет предохранительный для датчика частоты сердечного ритма:

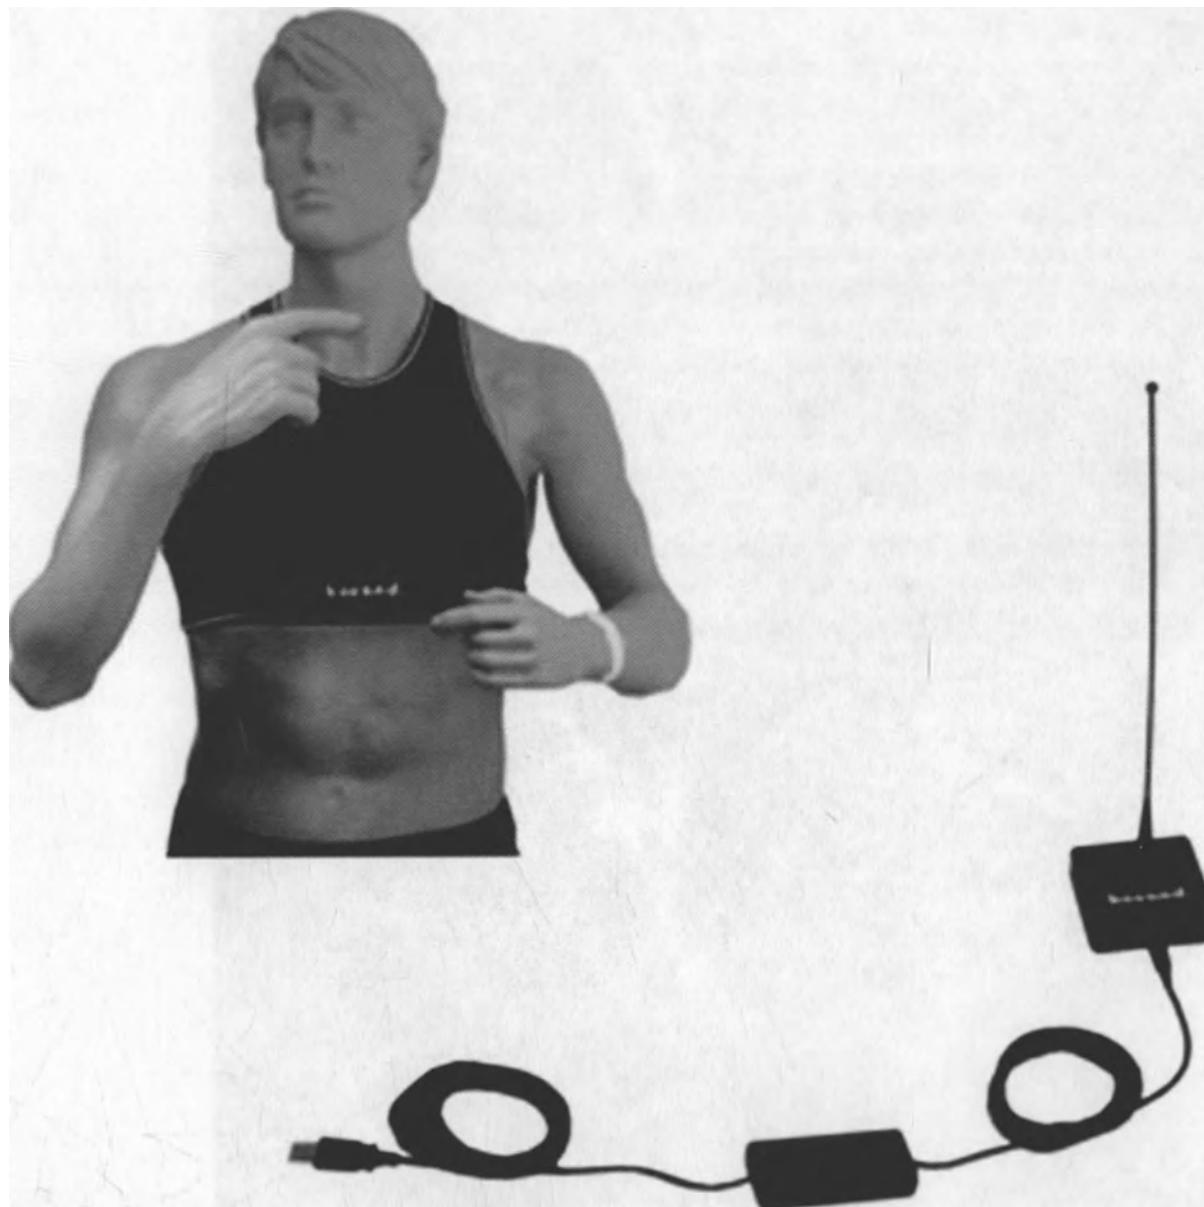

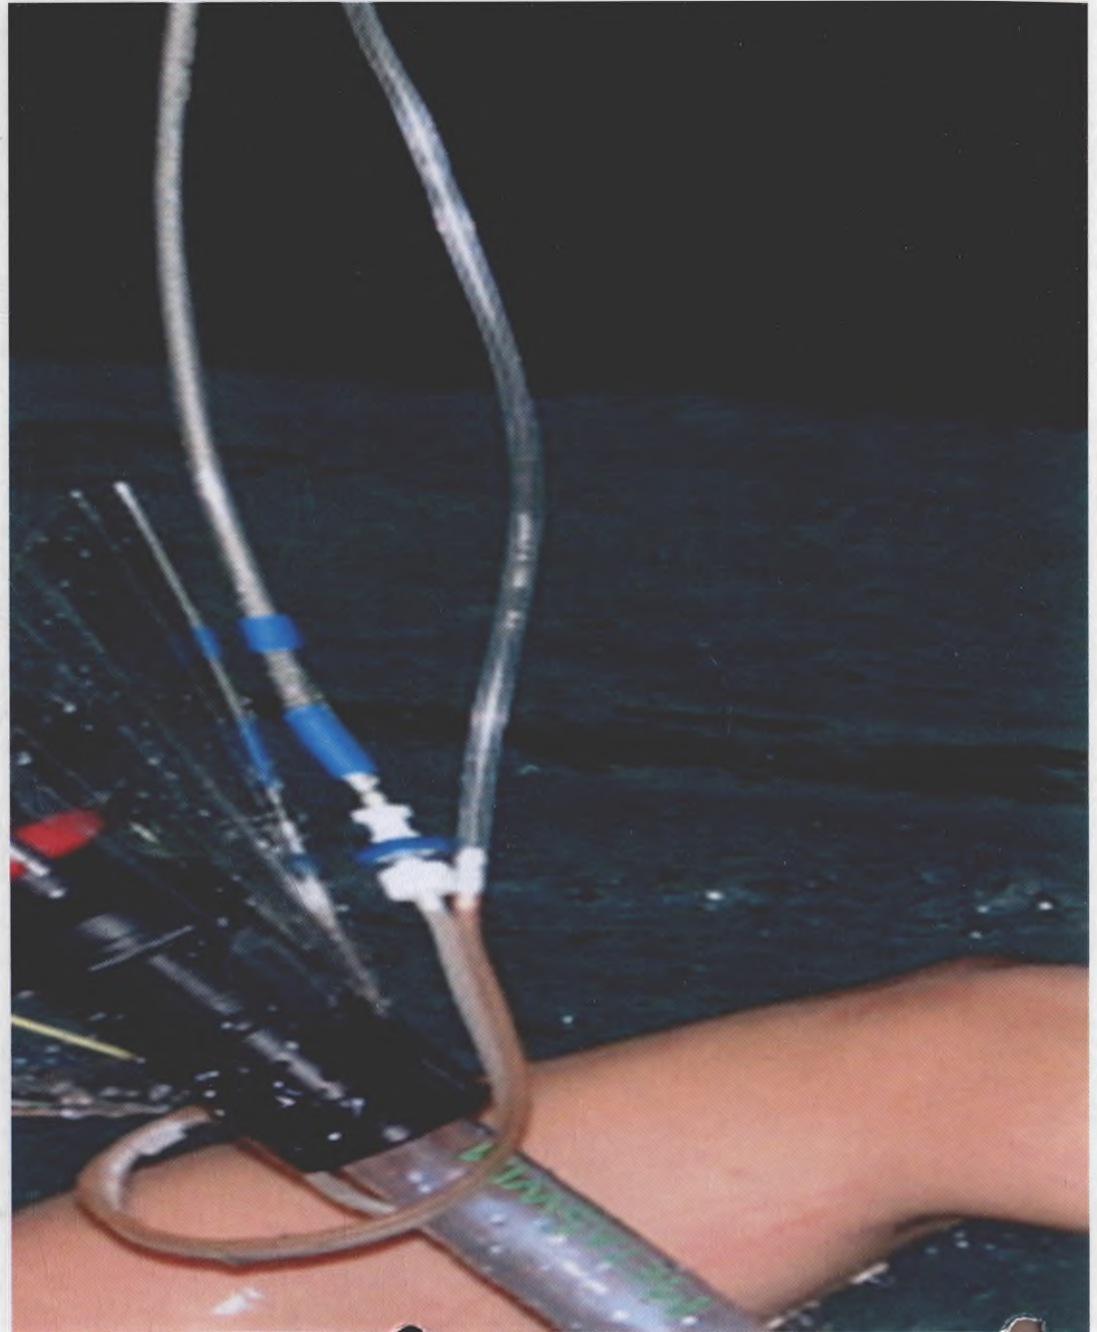



57.Короб защитный системного блока для системы MetaSwim:

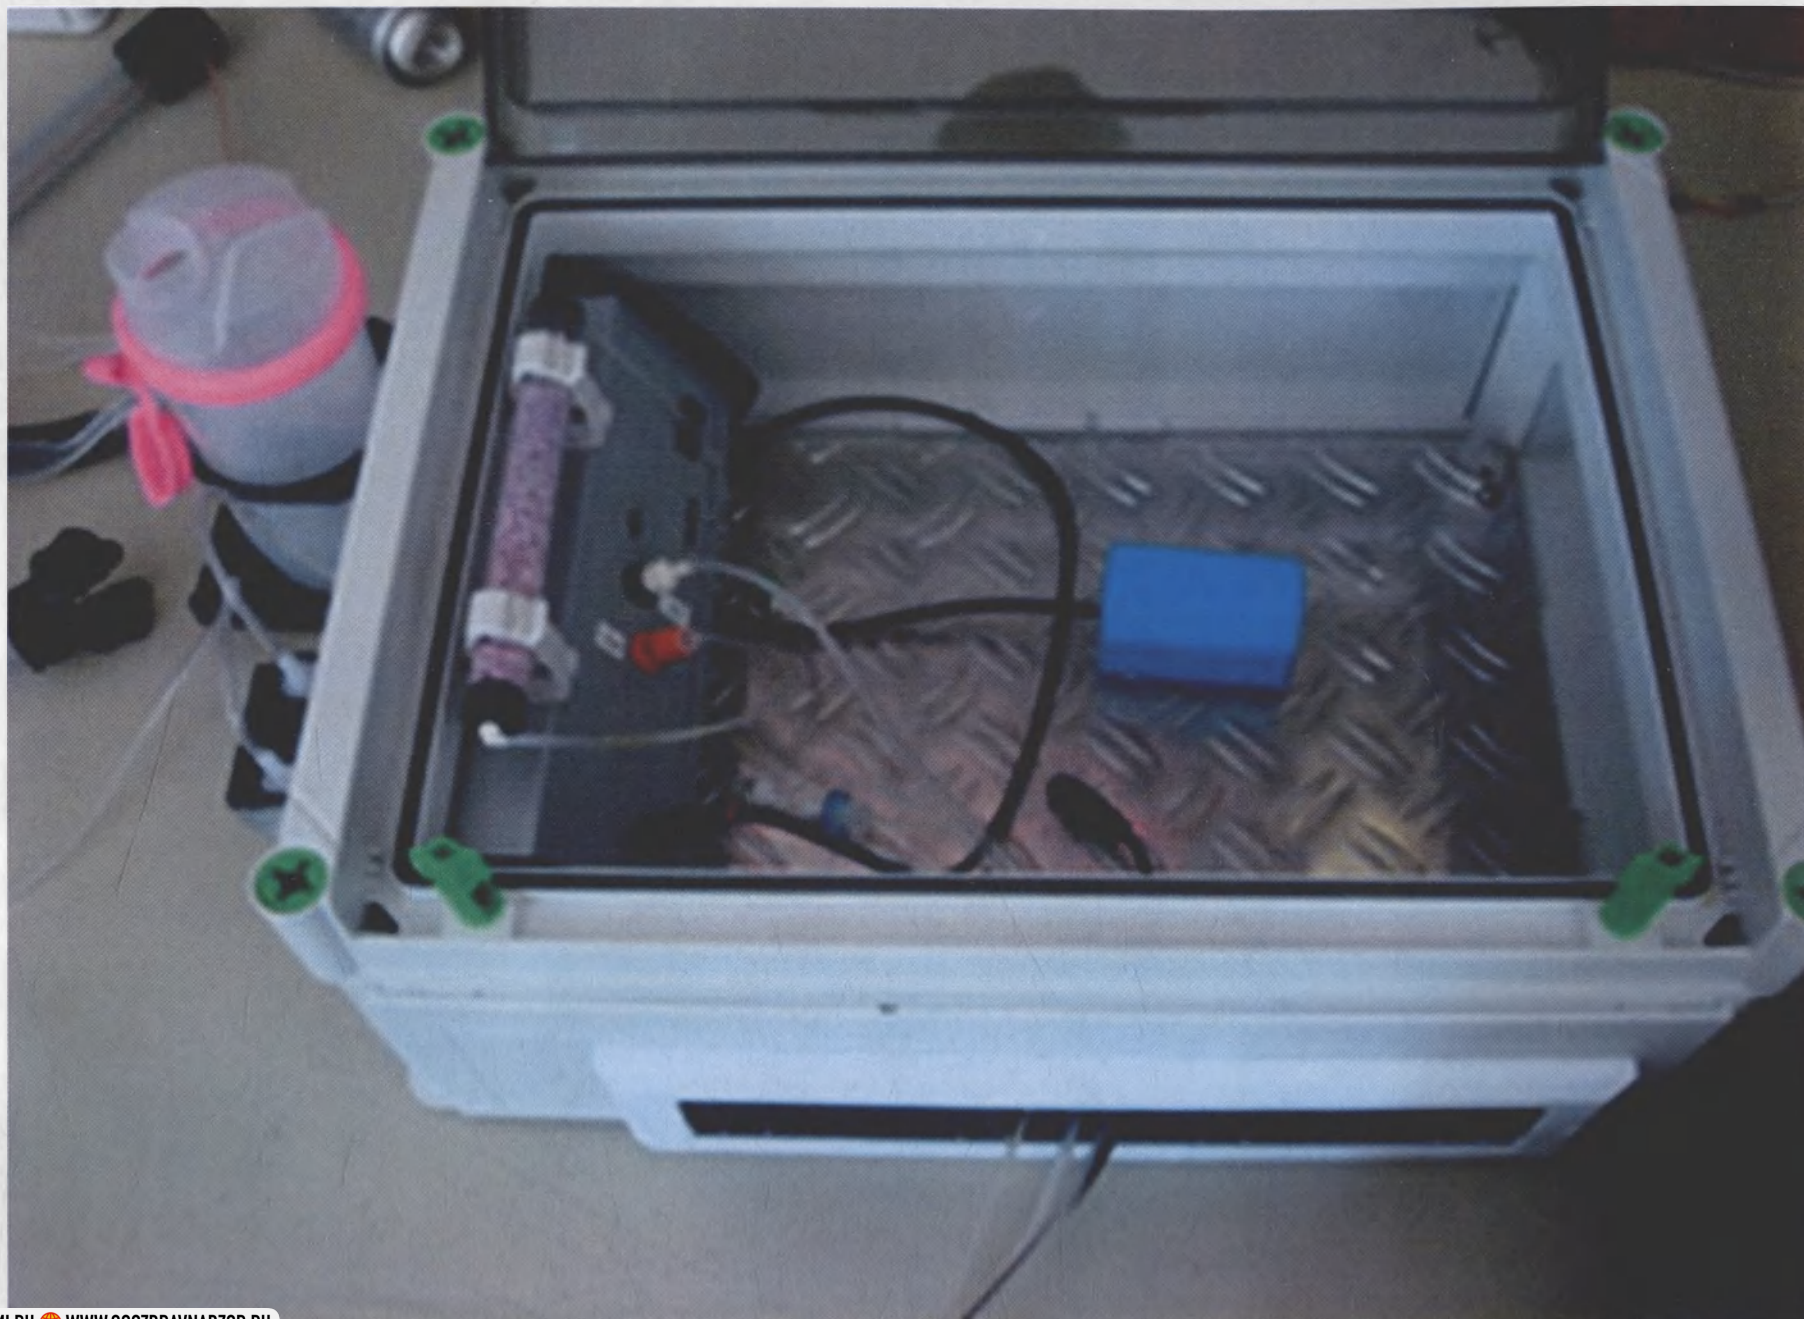

Всего прошнуровано,

пронумеровано и скреплено

печатью ООО "Эмера"

(*Сидорова Н.С.*) листов

Ген. дир. *Н.С. Сидорова* Сидорова Н.С.

