

**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 01, серия 02.**

Комплект №2 «РНК Магнит» Серия 02 от 2021.04.12

Вид сверху открытой коробки набора реагентов





**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.02 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,
Серия 02 от 2021.04.12 (не в сборе)**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
НАБОРОВ И ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ЭКОлаб

ЭКОлаб

ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2
"РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-120-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.02

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 02

Годен до: 2022.04.12



IVD

-24°C



Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк», серия 02 от 2021.04.12



Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов
«КовидЭк», серия 02 от 2021.04.12



Фото флаконов с реагентами для выделения РНК набора реагентов
«КовидЭк»,
серия 02 от 2021.04.12



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Борисов В.Ю.



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 01, серия 02.


Комплект №1 «РНК Экстракт» Серия 01 от 2021.04.12

Вид сверху открытой коробки набора реагентов





Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.01 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,
Серия 01 от 2021.04.12 (не в сборе)

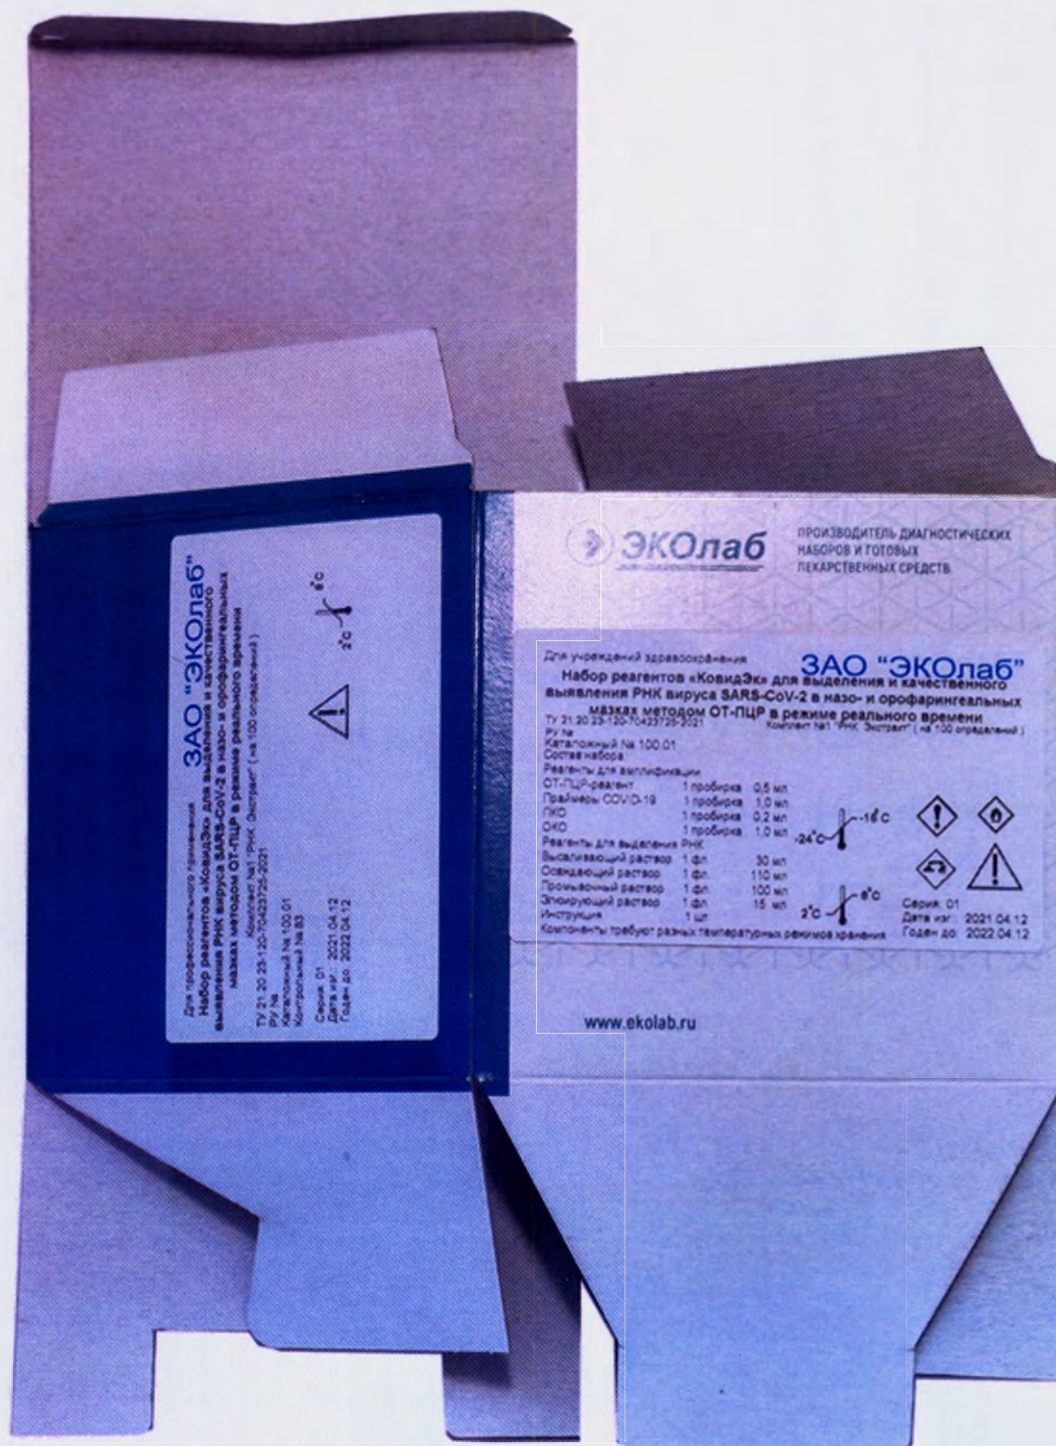



ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №1
"РНК Экстракт"

ТУ 21.20.23-120-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент	1 пробирка	0,5 мл
Праймеры COVID-19	1 пробирка	1,0 мл
ПКО	1 пробирка	0,2 мл
ОКО	1 пробирка	1,0 мл

Серия: 01

Годен до: 2022.04.12



IVD


-16°C




Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк», серия 01 от 2021.04.12



Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк», серия 01 от 2021.04.12

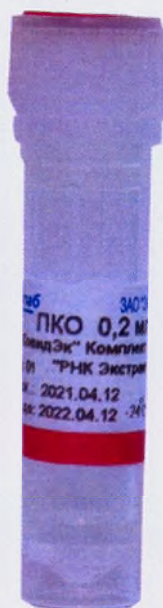



производитель диагностических
наборов и лекарственных
препаратов

ИНСТРУКЦИЯ по применению

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени,
серия 01, серия 02
ТУ 21.20.23-120-70423725-2021



ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №1
"РНК Экстракт"

ТУ 21.20.23-120-70423725-2021

Р/У №

Кат. № 100 01

Реагенты для амплификации

ОТ-ПЦР-реактив

Прямой раствор

Экстракционный раствор

Ингибиторный раствор

Серия 01

Годен до: 2022.04.12

10°C



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
НАБОРОВ И ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени,
серия 01, серия 02
ТУ 21.20.23-120-70423725-2021

Р/У №

Каталожный № 100 01

Остаток набора

Реагенты для амплификации

ОТ-ПЦР-реактив

Прямой раствор

Экстракционный раствор

Ингибиторный раствор

Серия 01

Годен до: 2022.04.12

10°C

10°C

10°C

10°C

www.ekolab.ru



Фото флаконов с реагентами для выделения РНК набора реагентов
«КовидЭк», серия 01 от 2021.04.12



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Борисов В.Ю.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

16 лист 06
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"05" 05 2021 г.

