


Фотографии общего вида


медицинского изделия:


«Аппарат для гистологической обработки биологических тканей»

производства

Ralf W.Weinkauf (Ральф В. Вайнкауф), Ringstrasse 28, 91352, Hallerndorf, Германия

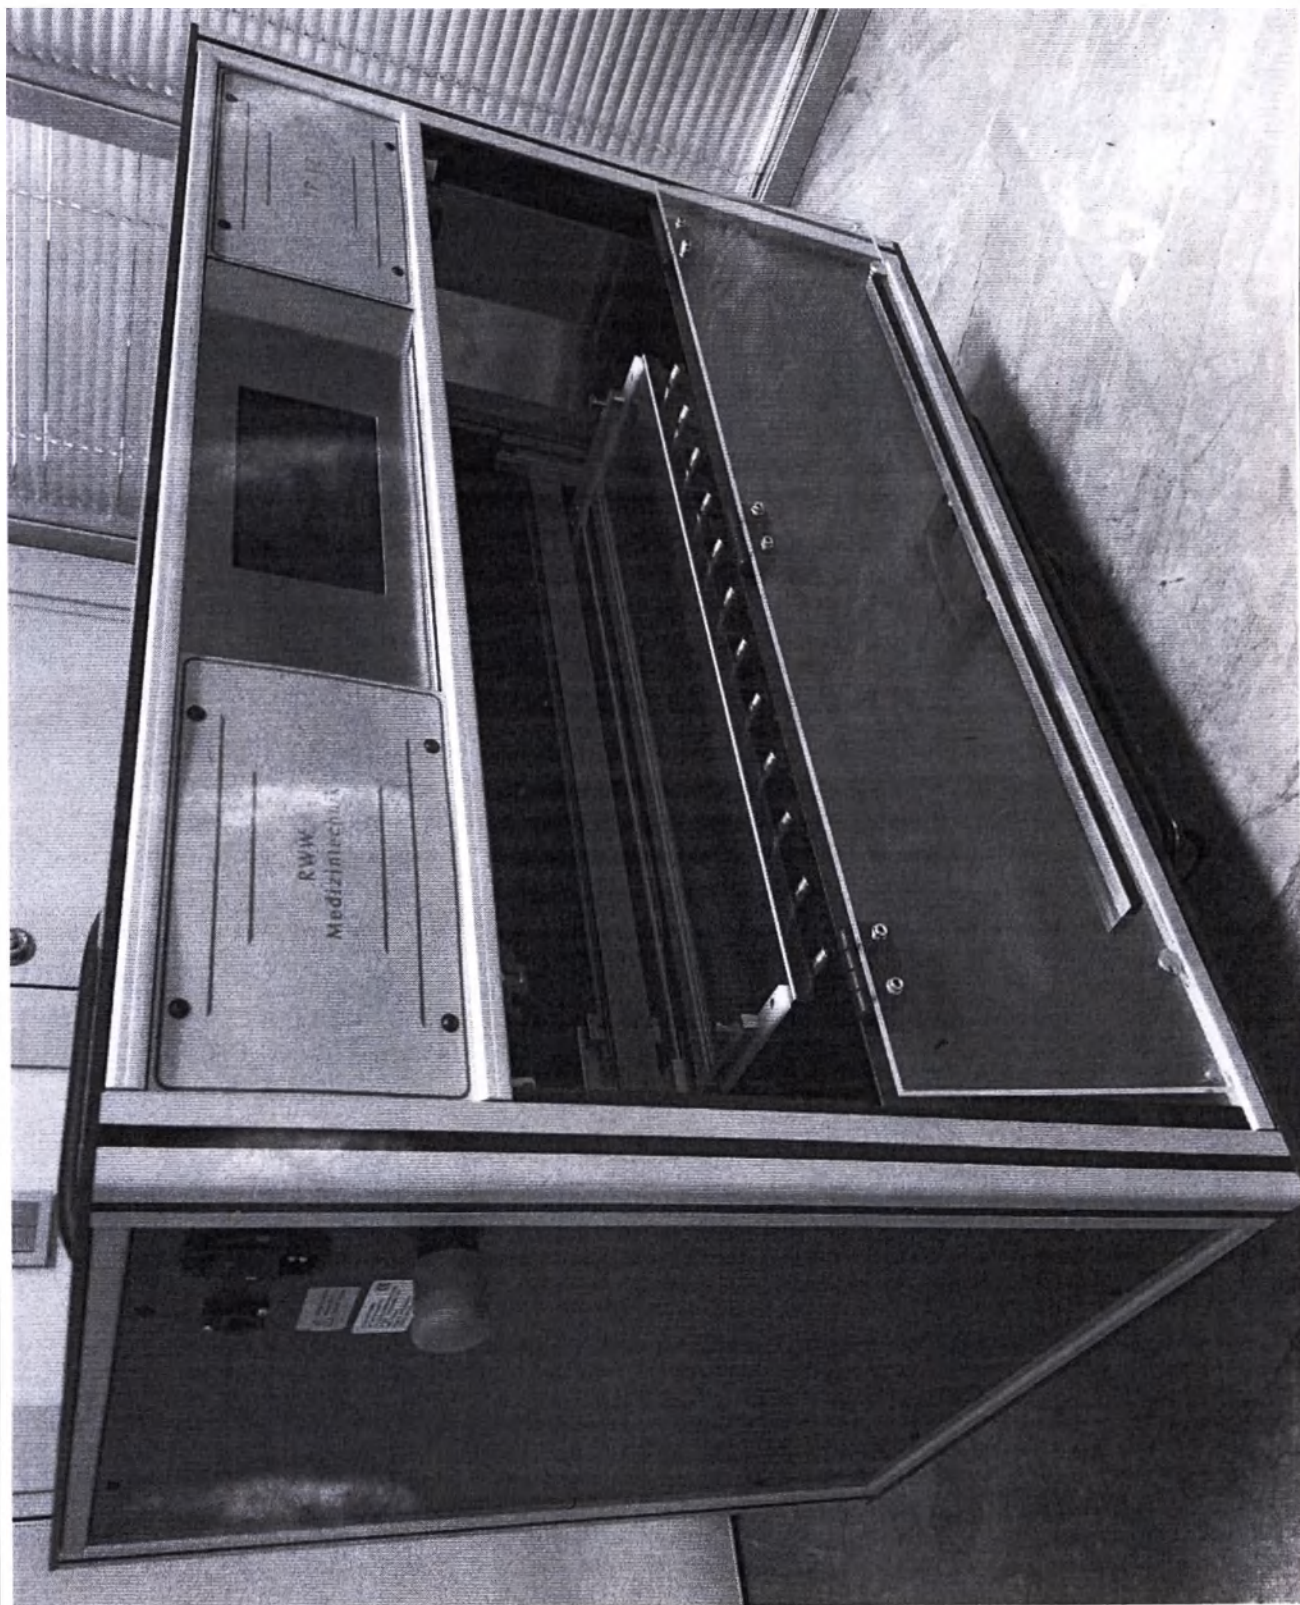


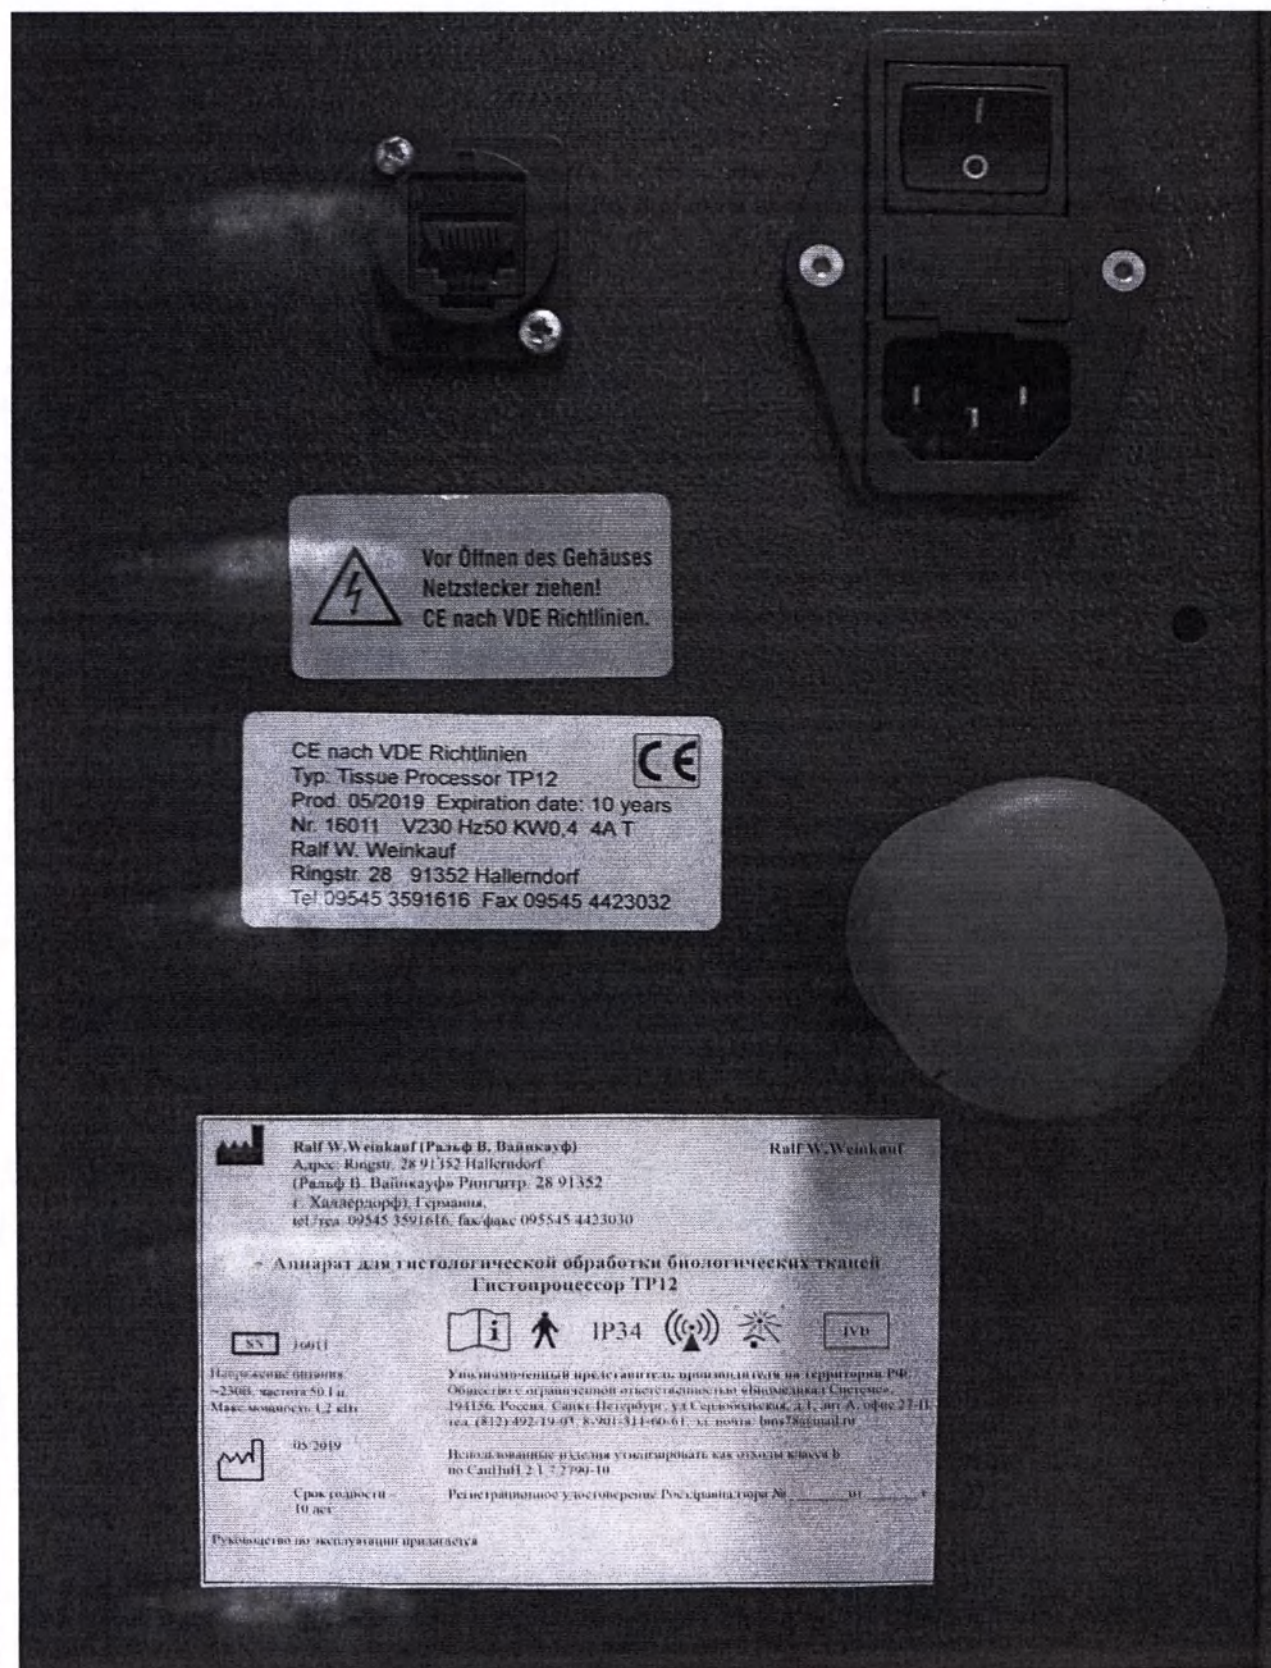


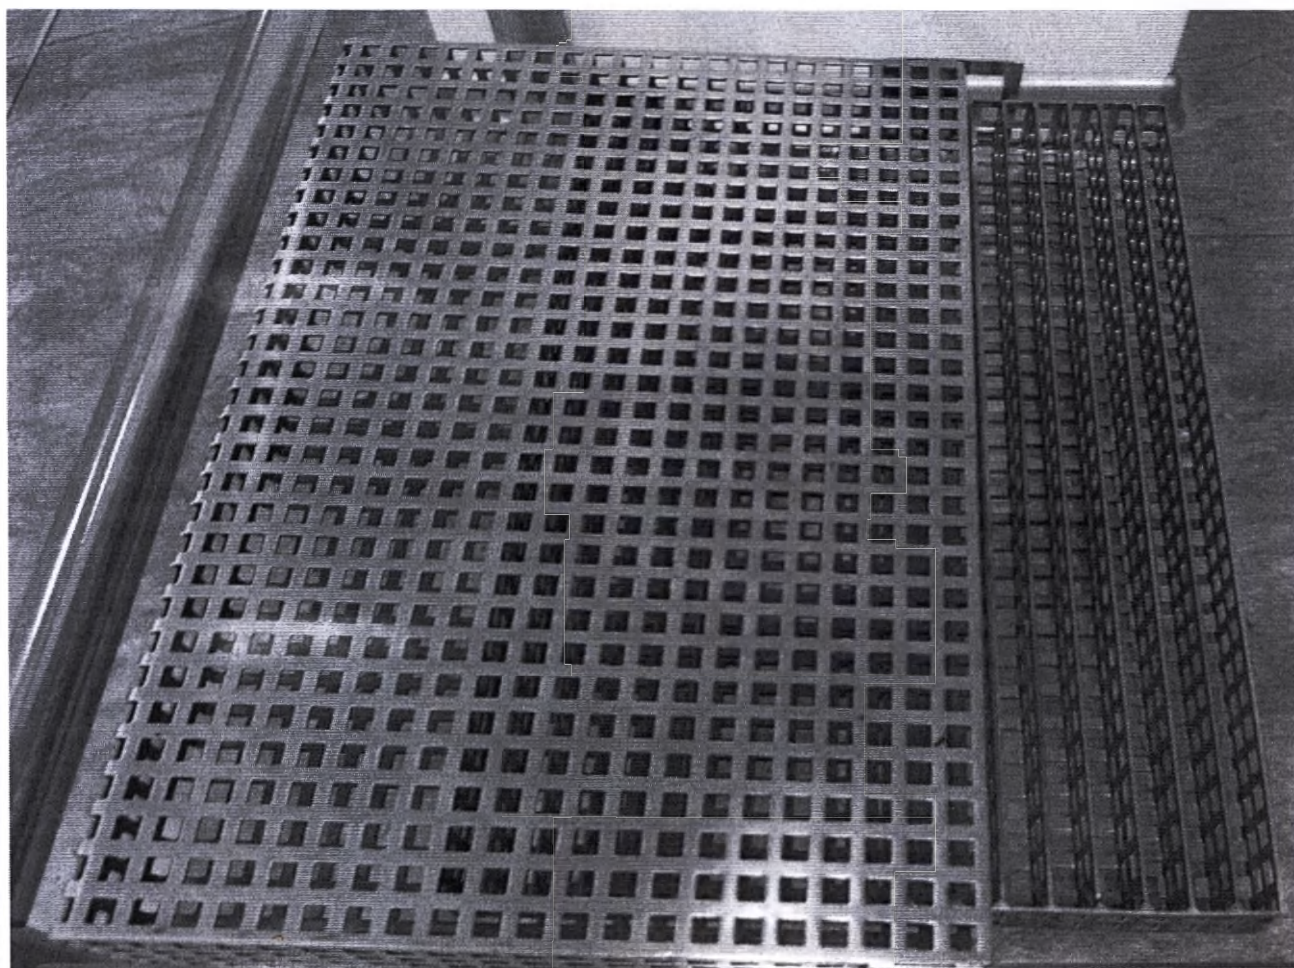





Корзина аппарата
для гистологической
обработки биологических
тканей TP12
Ralf W. Weinkauff

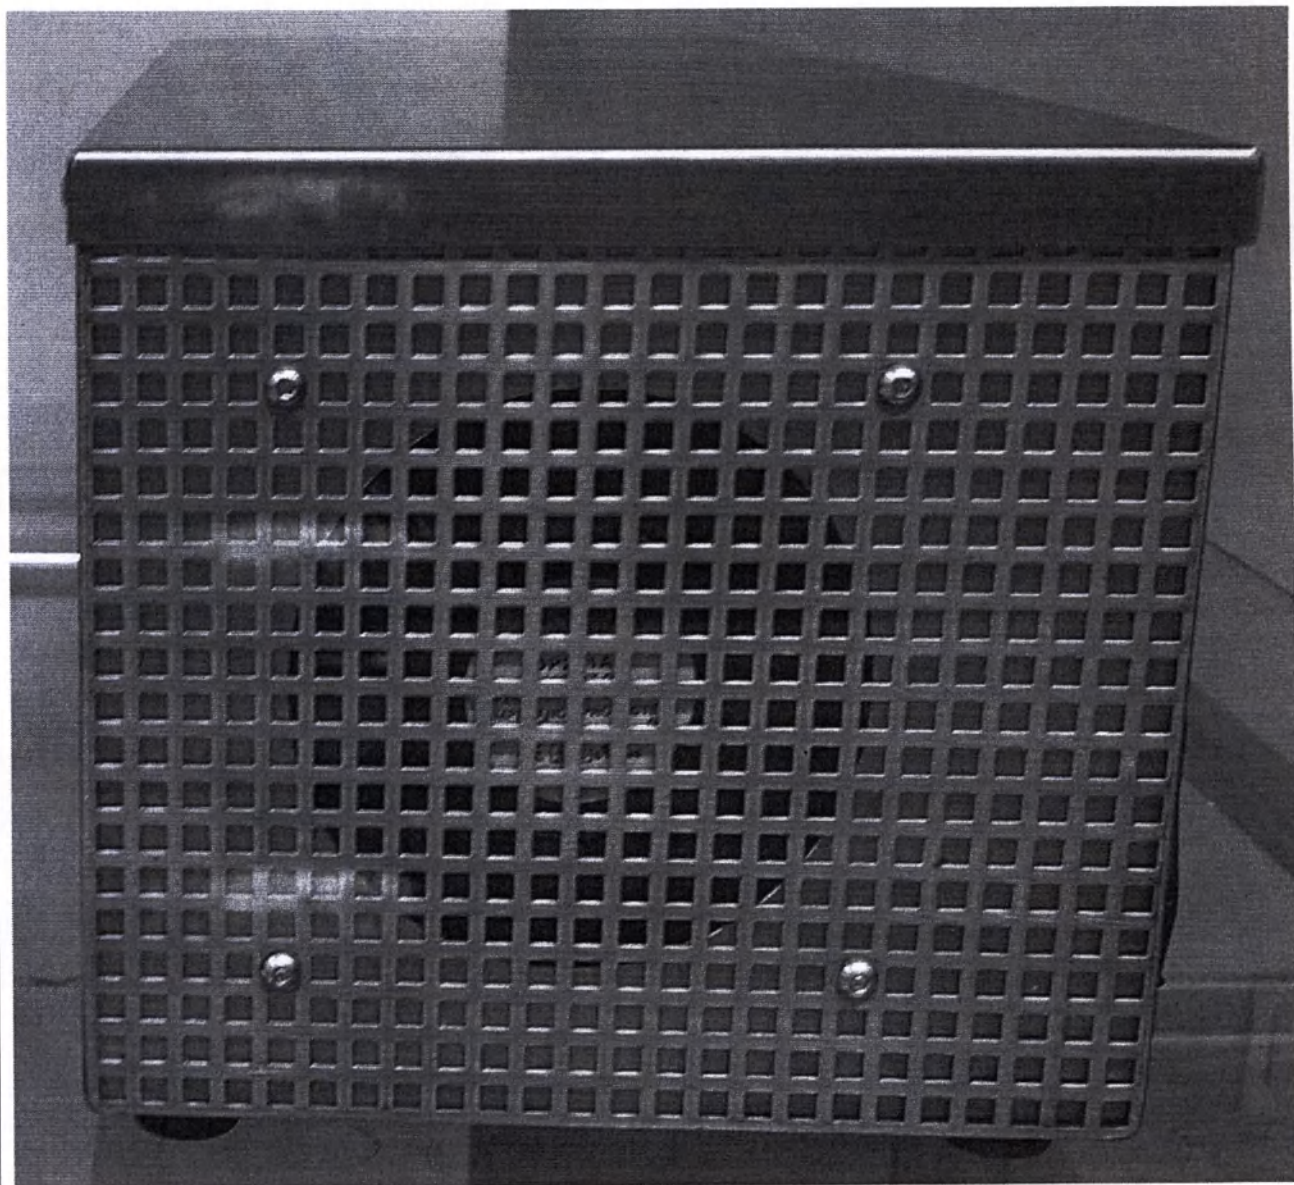


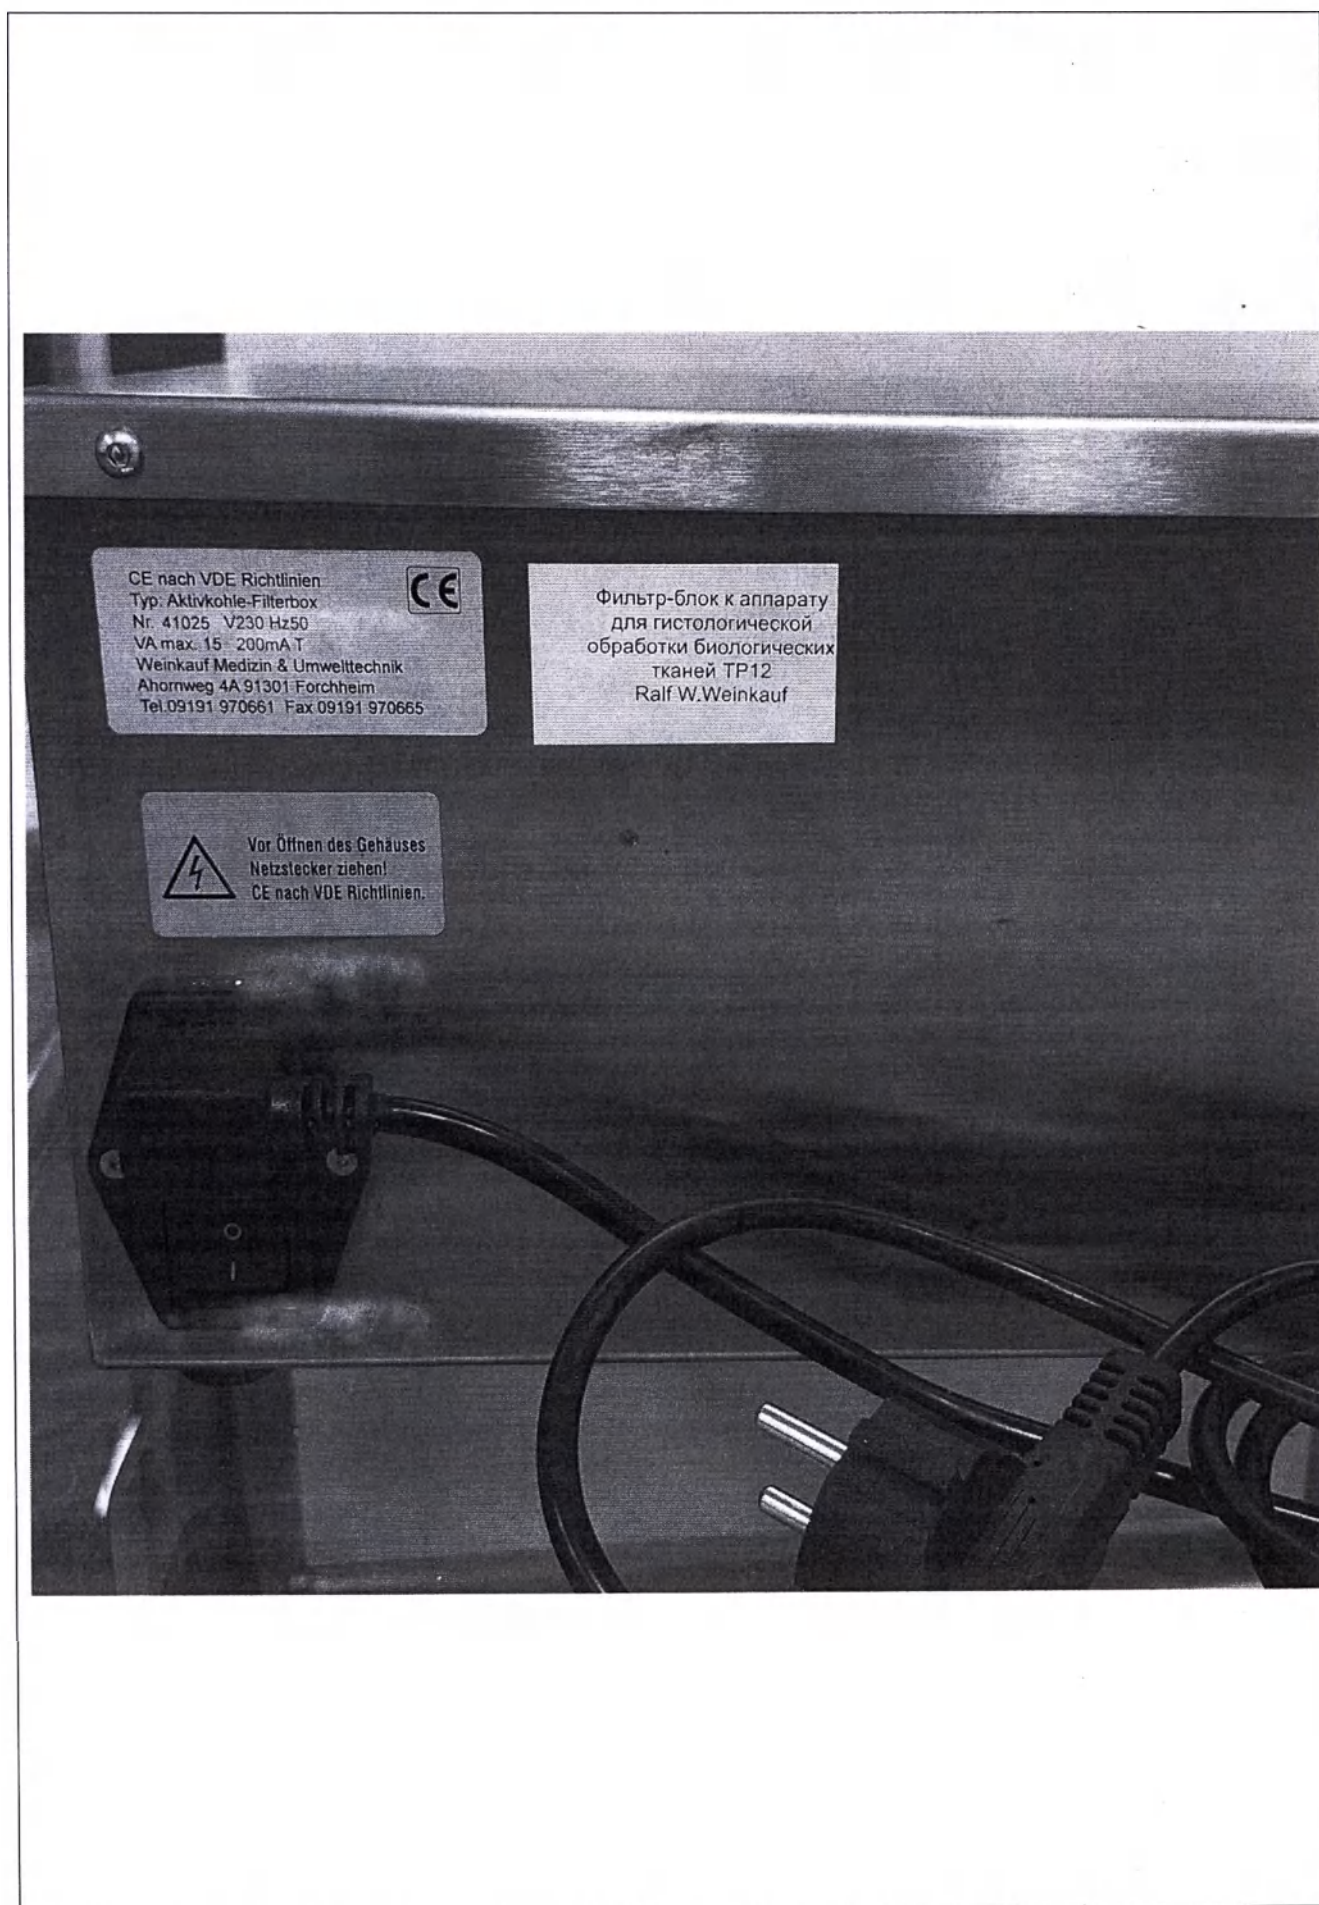

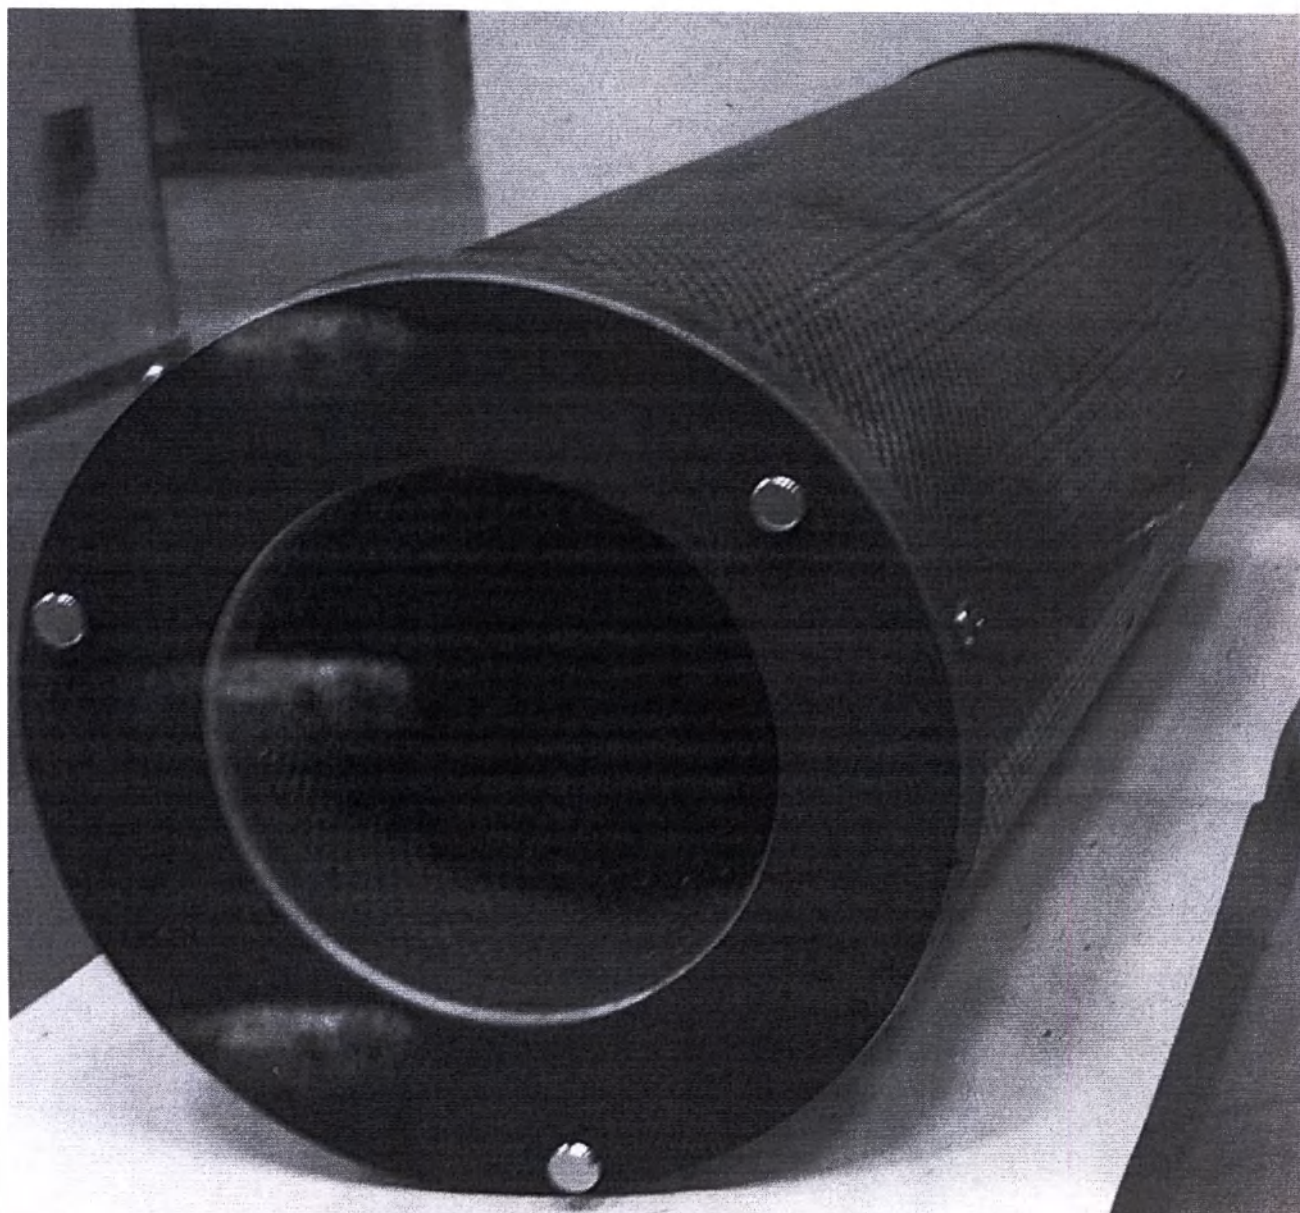

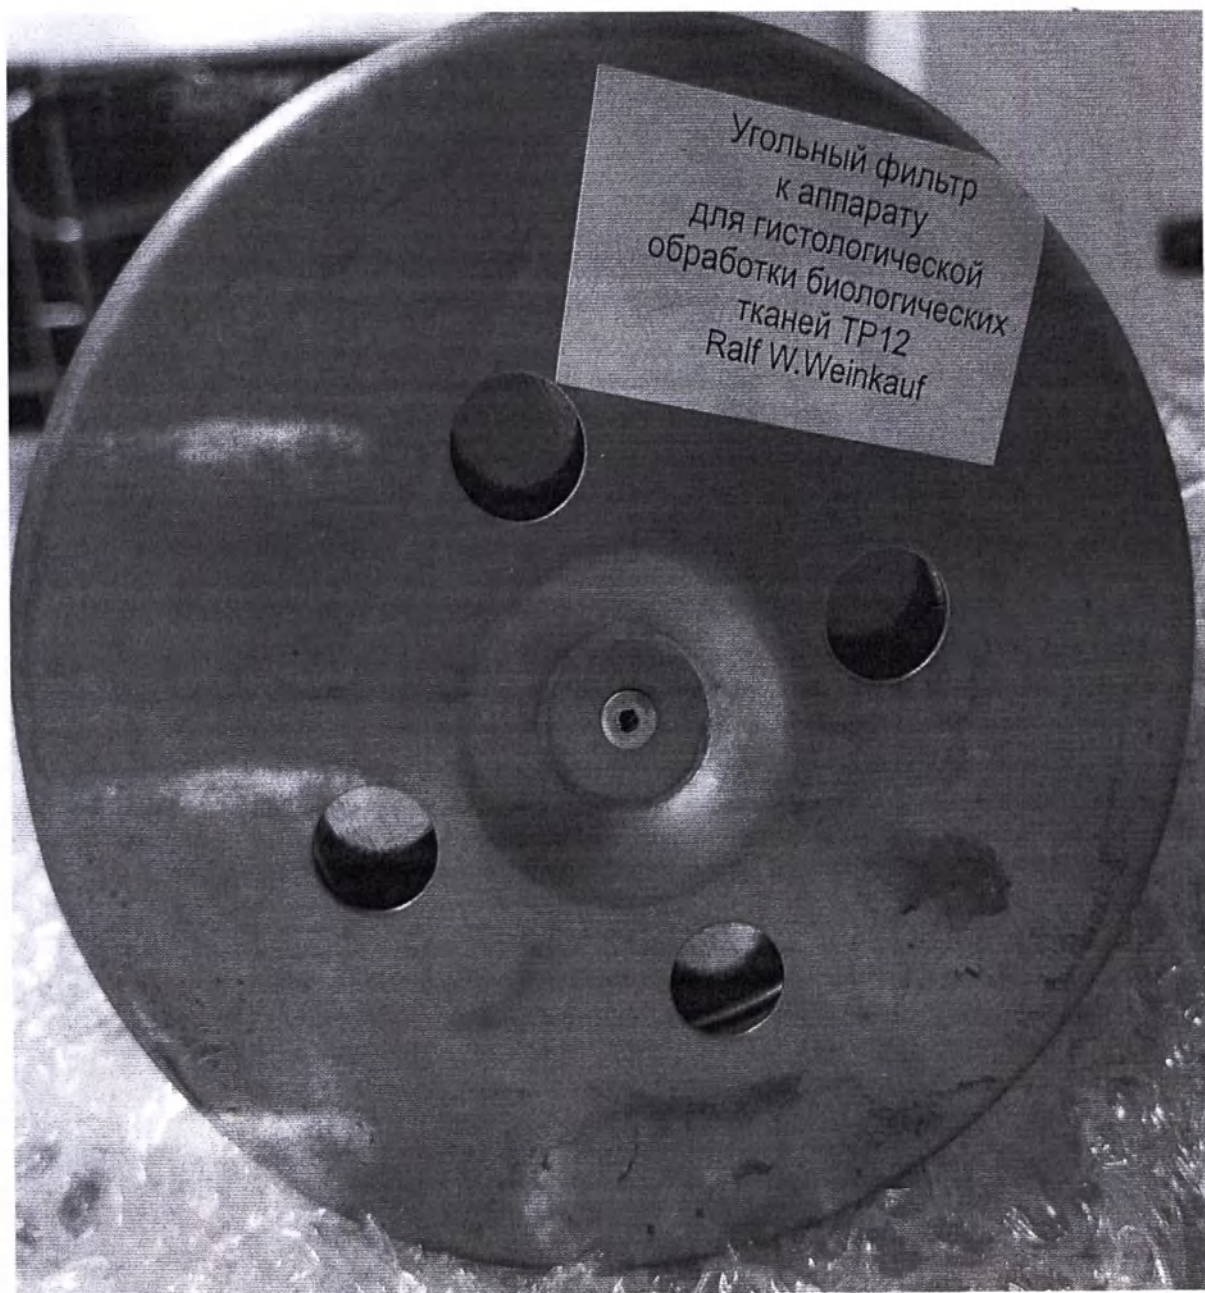



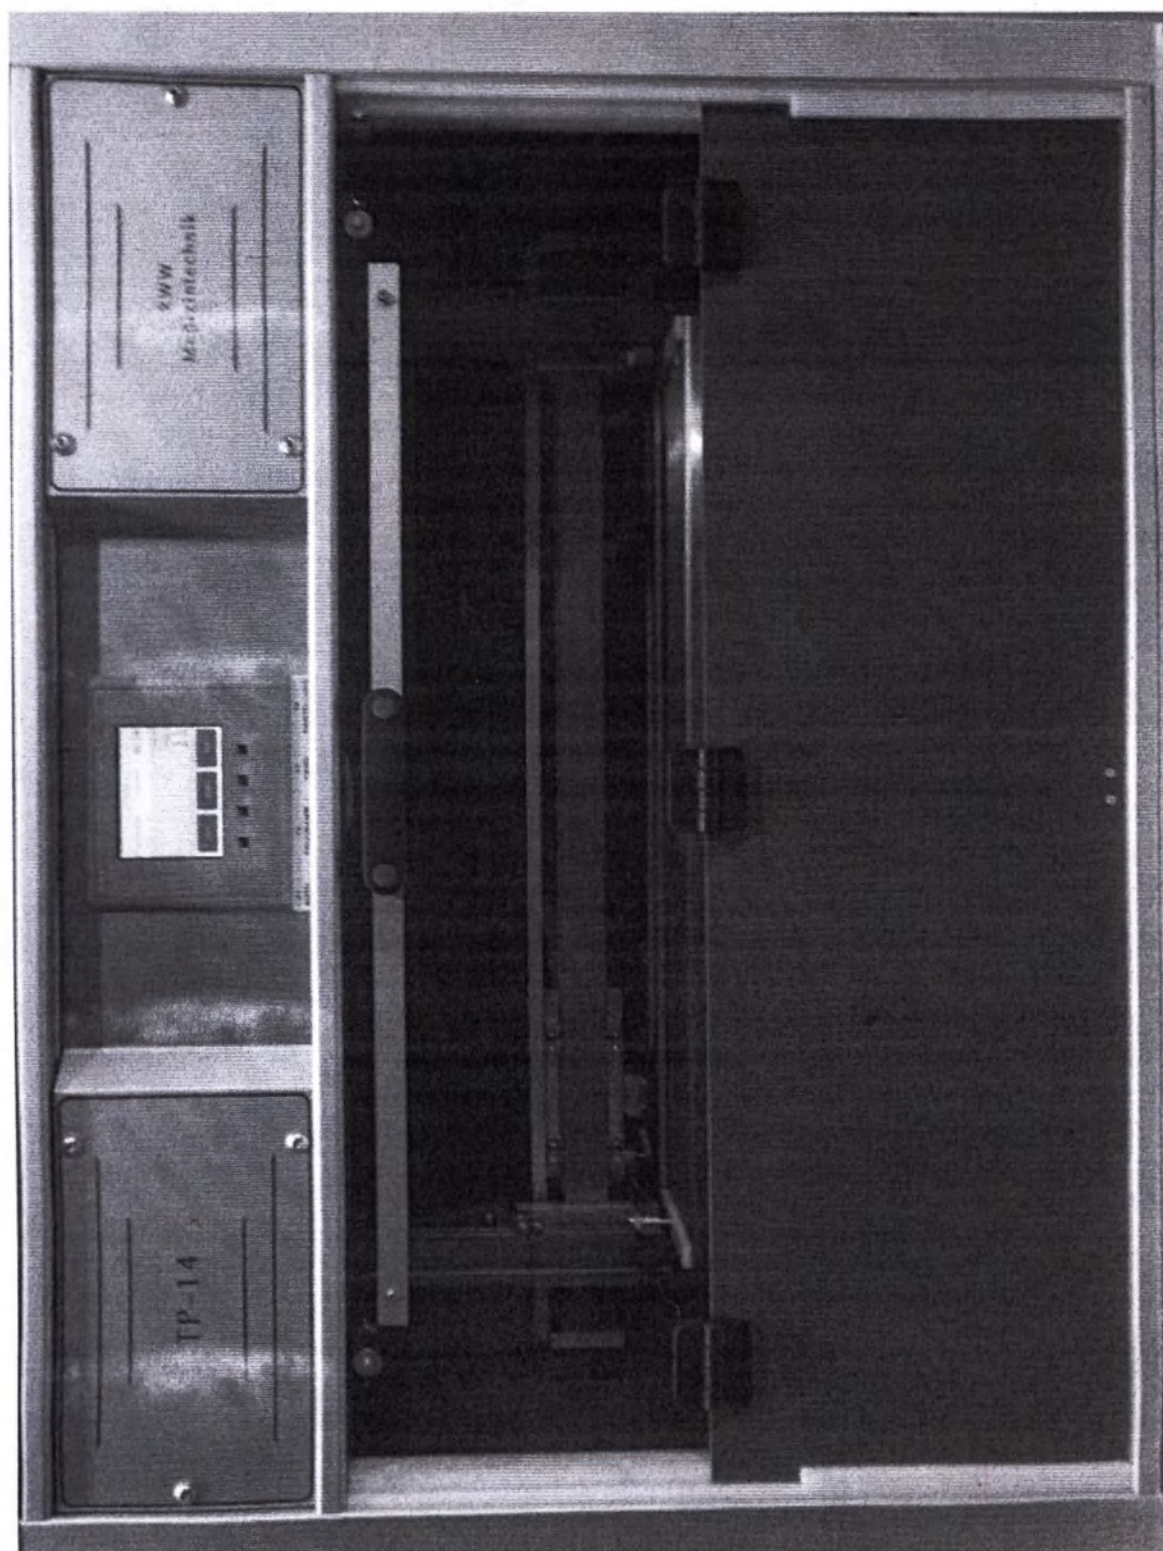



Vor Öffnen des Gehäuses
Netzstecker ziehen!
CE nach VDE Richtlinien.

CE nach VDE Richtlinien
Typ: Tissue Processor TP14
Prod. 05/2019 Expiration date: 10 years
Nr. 16011 V230 Hz50 KW0,4 4A T
Ralf W. Weinkauff
Ringstr. 28 91352 Hallerndorf
Tel.09545 3591616 Fax 09545 4423032



Ralf W. Weinkauff (Ральф В. Вайнкауф)
Adresse: Ringstr. 28 91352 Hallerndorf
(Ральф В. Вайнкауф) Ringstr. 28 91352
г. Халлерндорф, Германия,
tel./тел. 09545 3591616; fax/факс 09545 4423032

Ralf W. Weinkauff

Аппарат для гистологической обработки биологических тканей
Гистопроцессор TP14

SN 16011

Напряжение питания
~230В, частота 50 Гц
Макс. мощность 1,2 кВт



05/2019

Срок годности -
10 лет

Руководство по эксплуатации прилагается




IP34



Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Биомедикал Системс»,
194156, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.1, лит. А, офис 27-11,
тел. (812) 492-19-03, 8-901-344-60-61, e-mail: bms@bms.ru

Использованные изделия утилизировать как отходы класса В
по СанПиН 2.1.7.2790-10

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № _____ от _____

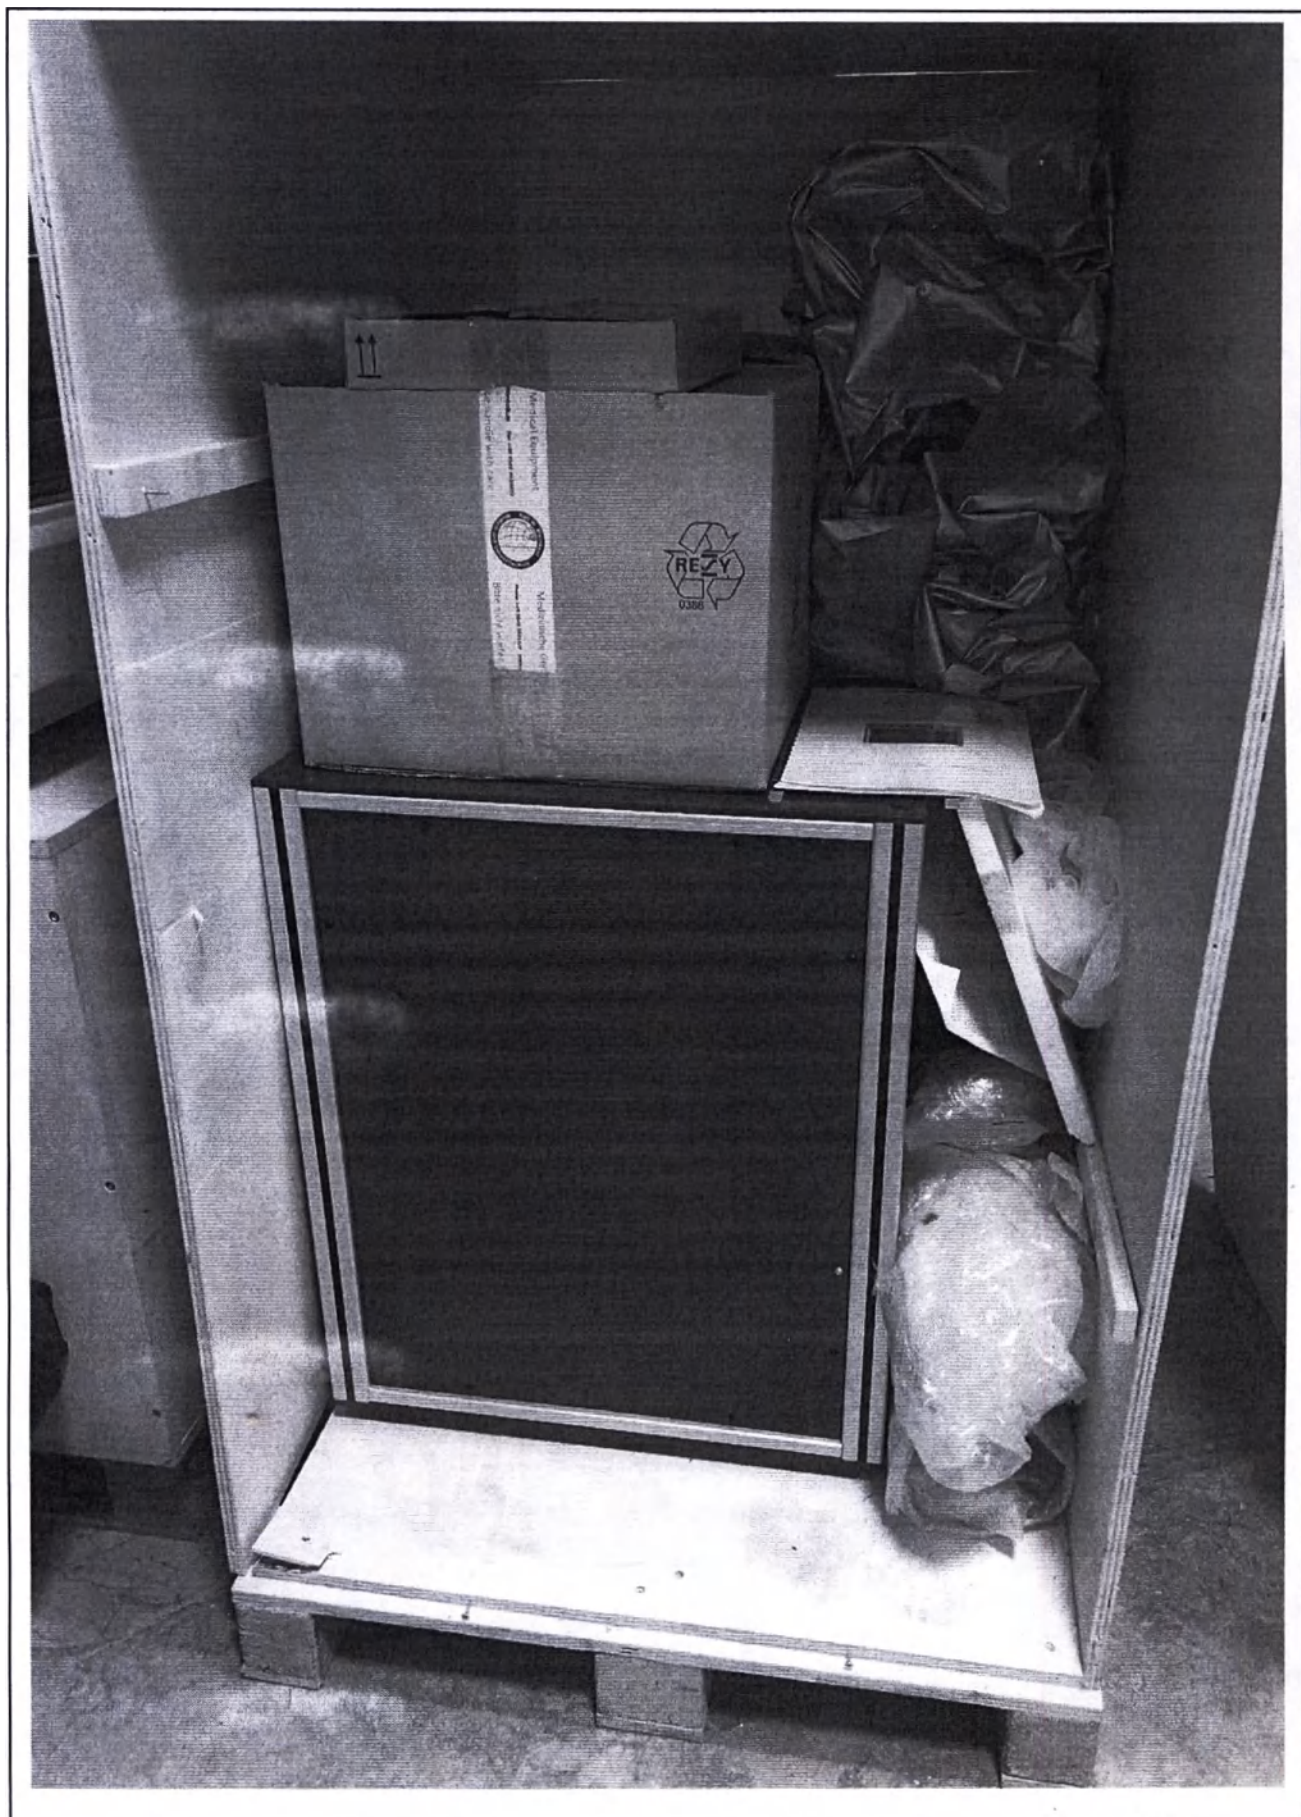



Принимается и
применяется на 14 (редпр-
написательстве)
Ген. директор В. Березин

