

Фотографические изображения

Винт костный,

производства «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Республика Корея



Винт костный Bone Screw, варианты исполнения:

- BSCH2008 (Ø2.0*8 мм)
- BSCH2010 (Ø2.0*10 мм);
- BSCH2012 (Ø2.0*12 мм);
- BSCH2014 (Ø2.0*14 мм);
- BSCH2016 (Ø2.0*16 мм)

имеют идентичный внешний вид, отличаются только длиной.



Винт костный Bone Screw, варианты исполнения:

-BSCH1404 (Ø 1.4*4 мм);

-BSCH1406 (Ø 1.4*6 мм);

-BSCH1408 (Ø 1.4*8 мм);

имеют идентичный внешний вид, отличаются только длиной.




Винт костный Bone Screw, варианты исполнения:

-BSCH1203 (Ø1.2*3 мм);

-BSCH1204 (Ø1.2*4 мм);

-BSCH1205 (Ø1.2*5 мм);

имеют идентичный внешний вид, отличаются только длиной.


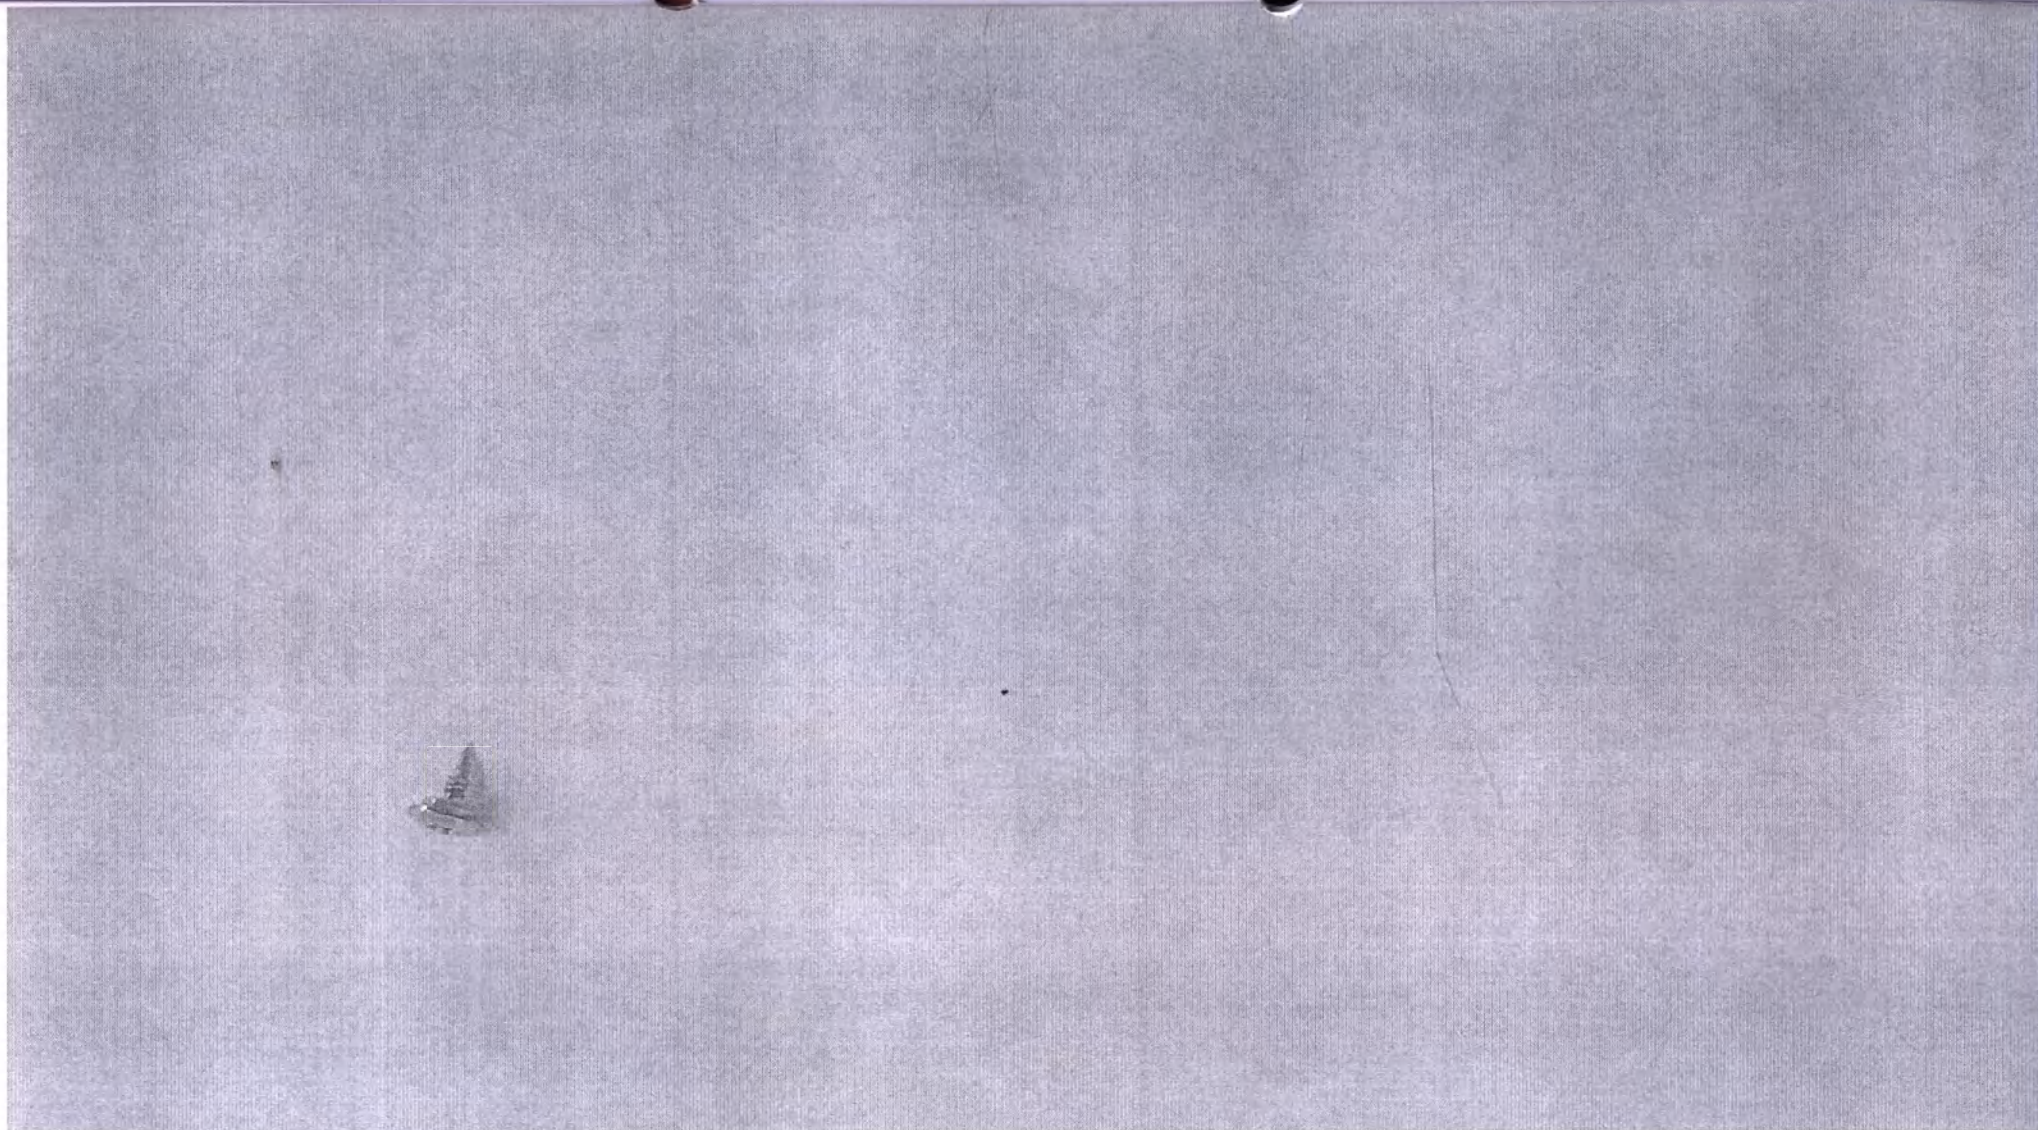


Винт костный Bone Task, OBT3 (3 мм)

Маркировка МИ на русском языке
па примере варианта исполнения «Винт костный Bone Tack, OBT3 (3 мм)»

STERILE		R
Винт Костный Bone Tack		
3mm		
REF	OBT3	
LOT		
		
		
Компания-представитель : ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, кор.7, эт.8, оф.1 +7-495-739-9925		
Применяют только врачом - специалистом		
№РЗН XXXX/XXXX		
	Одно Разовый	
	(01)08800000900018 (10)PTE15H002 (11)150805 (21)0060 (17)230804	

Винт костный

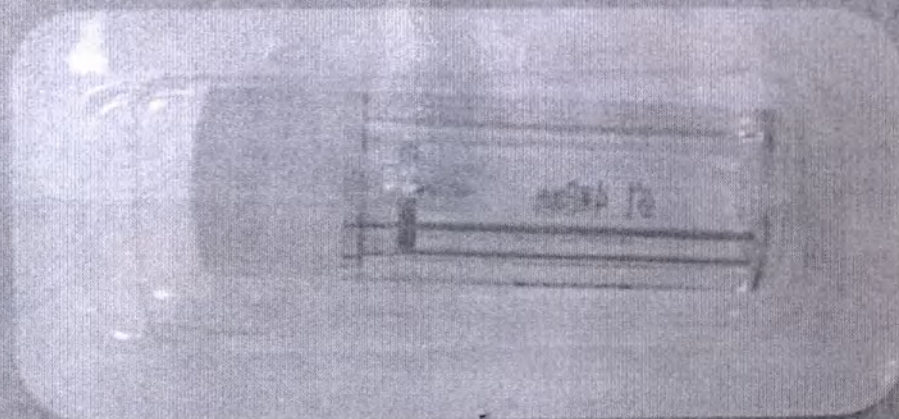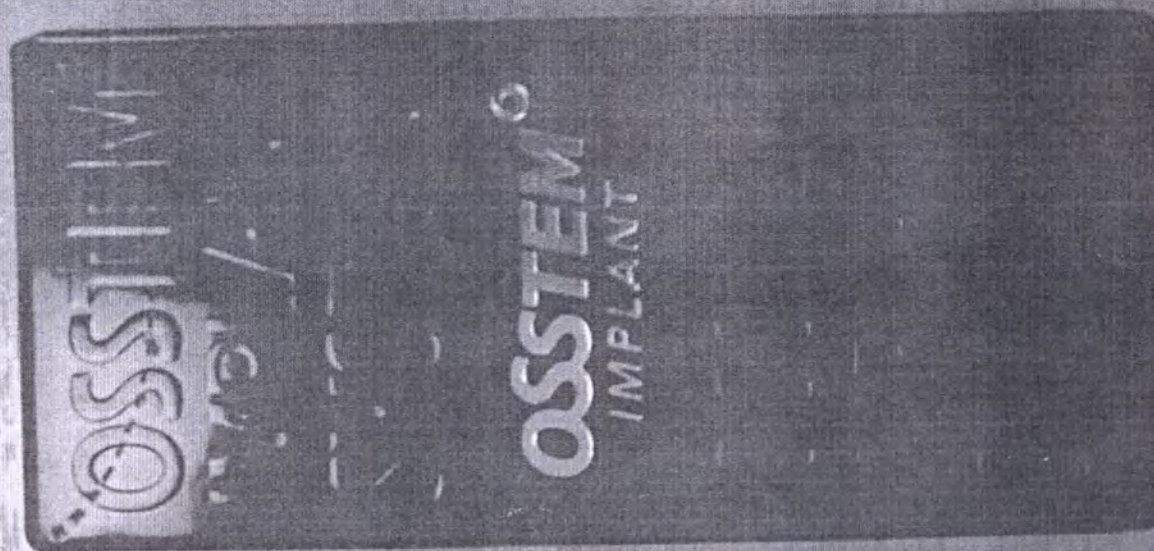

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись А. М. С. / М. Е. Коз

« 04 » 06 / 20 21 г.

