

Общество с ограниченной ответственностью

«Олимпас Москва»

Генеральный директор Андрей Типольт




Фотографическое изображение медицинского изделия

Инструменты эндохирургические с принадлежностями



Клип-аппликатор: А5679, А56790А (Макет маркировки)

Артикул	Клип-аппликатор: А5679
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

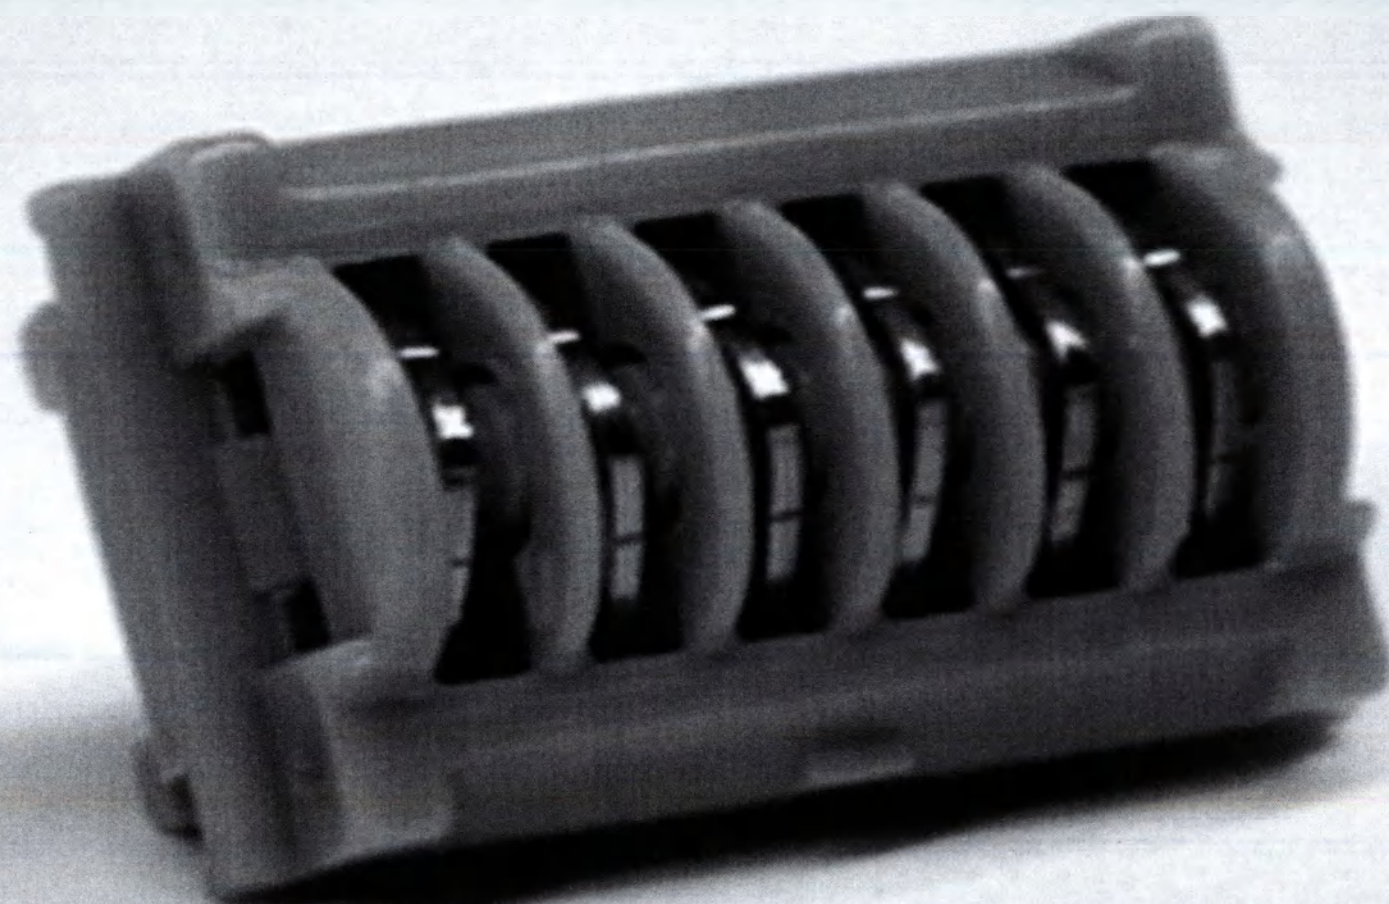

Клипсы: А5635 (18 х 6 шт.) (Макет маркировки)

Артикул	Клипсы: А5635 (18 х 6 шт.)
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



3. Низводитель узлов: WA56903A, WA63790A, WA69080L, WA69080M, WA69082L, WA69082M.

Низводитель узлов: WA56903A (макет маркировки)


Артикул	Низводитель узлов: WA56903A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



II. ИНСТРУМЕНТЫ КОЛЮЩИЕ: Игла Вереша: O5151.1, O5152.1, A5150.1, A0555, A0556.

Игла Вереша: O5151.1 (макет маркировки)


Артикул	Игла Вереша: O5151.1
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

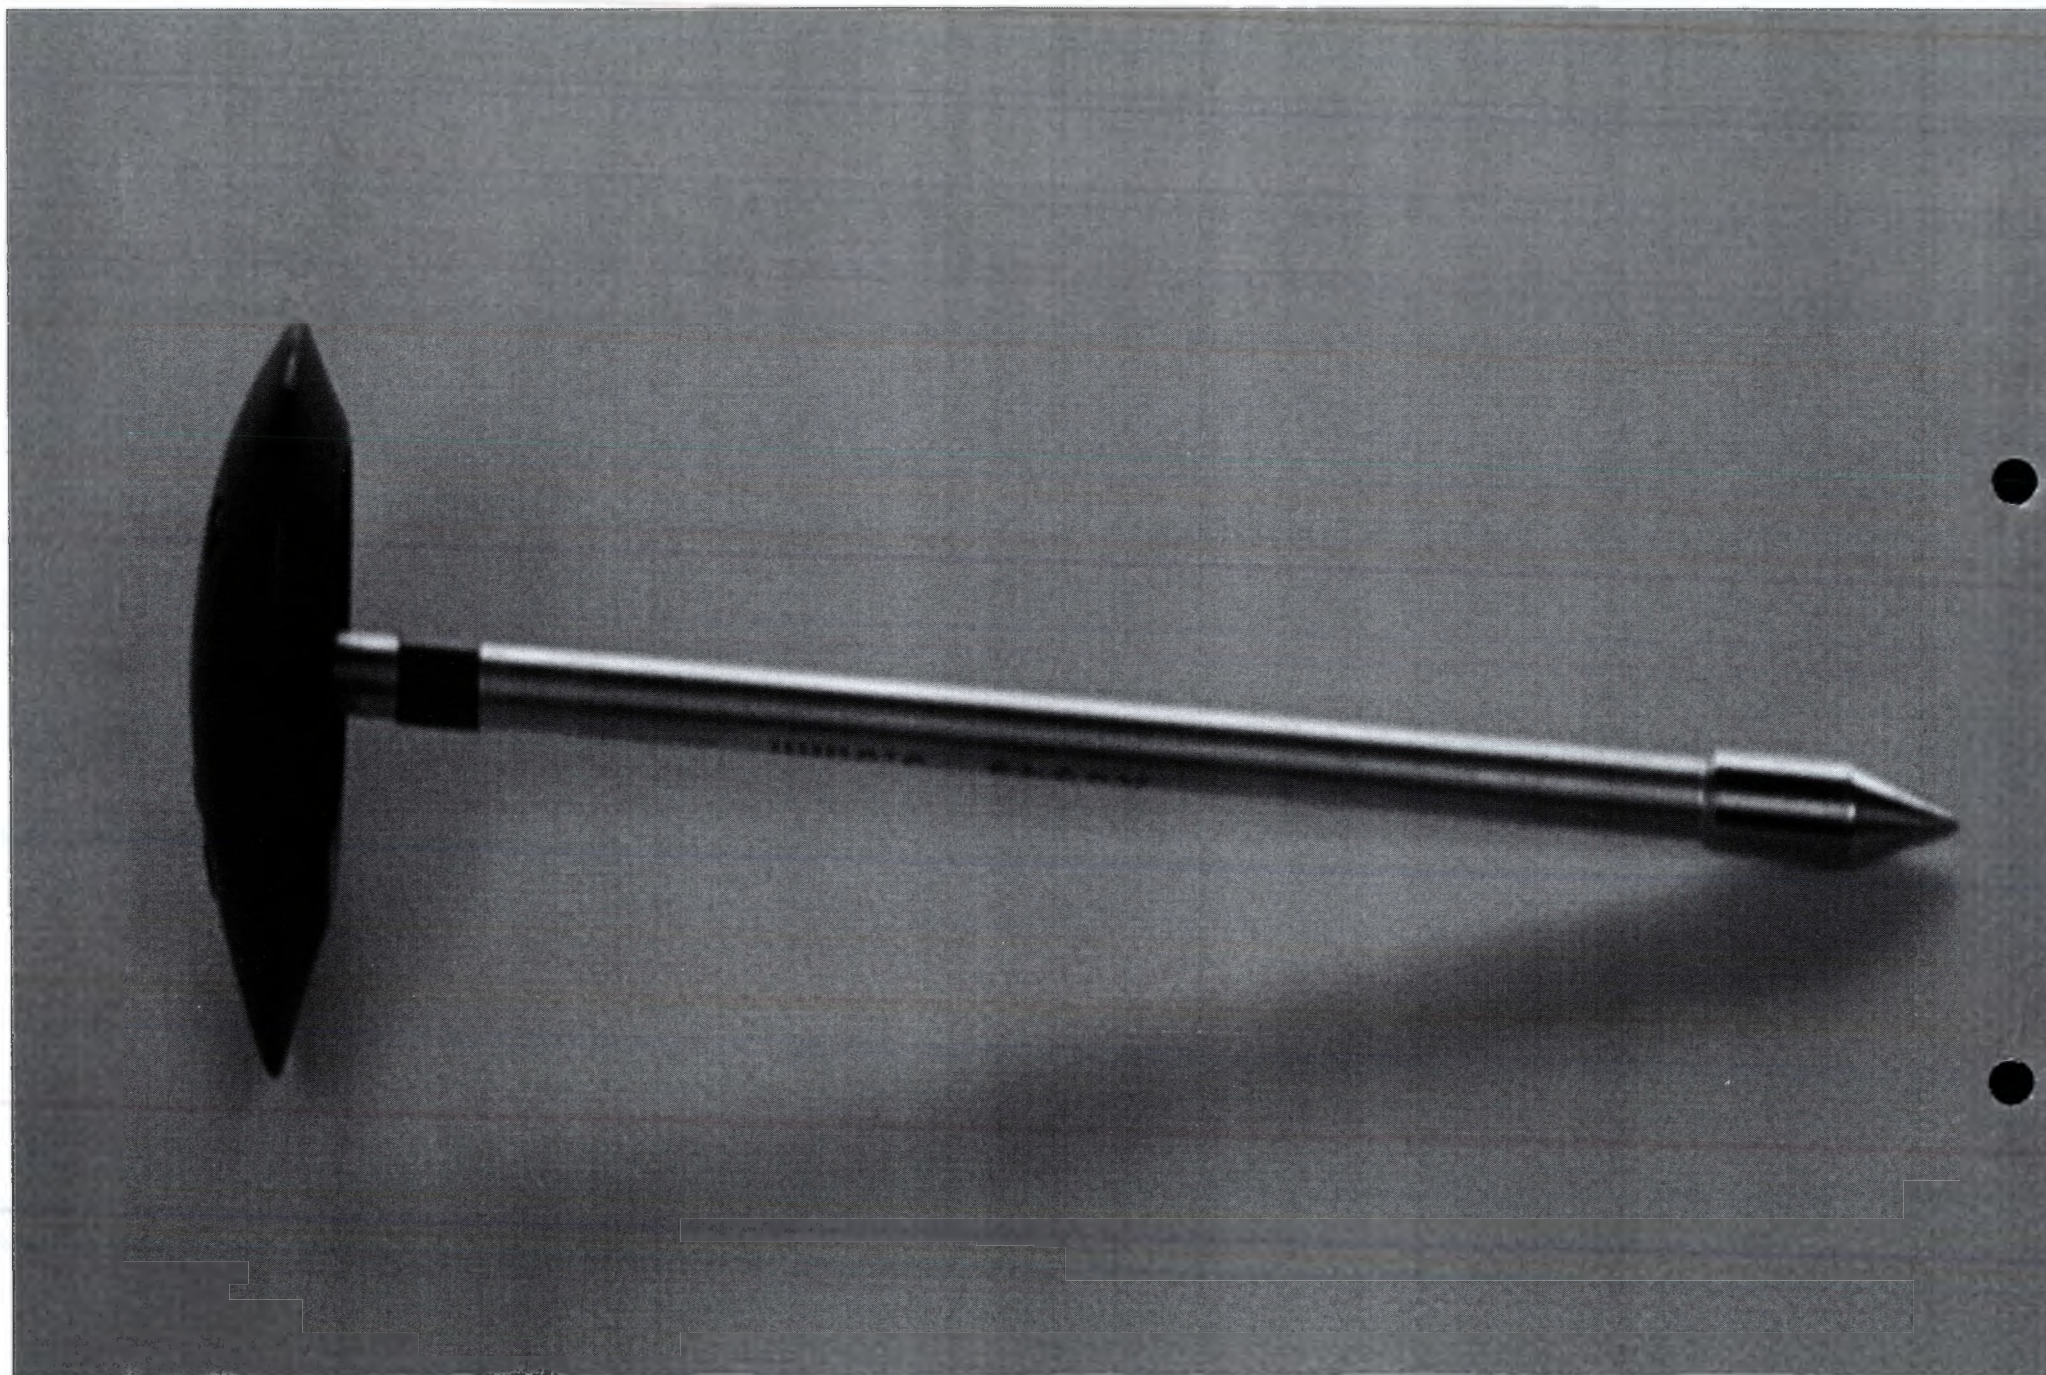

2. Троакар: A4781, A5552, A5563, A5564, A5565, A5670, A5688, A5690, A5692, A5761, A5816, A5817, A5821, WA58341L, WA58343L, WA58345S, WA58365S, WA58385S, WA70054A, WA70055A, WA70074A, WA70075A, WA70078A, WA70079A.

Троакар: А4781 (макет маркировки)

Артикул	Троакар: А4781
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

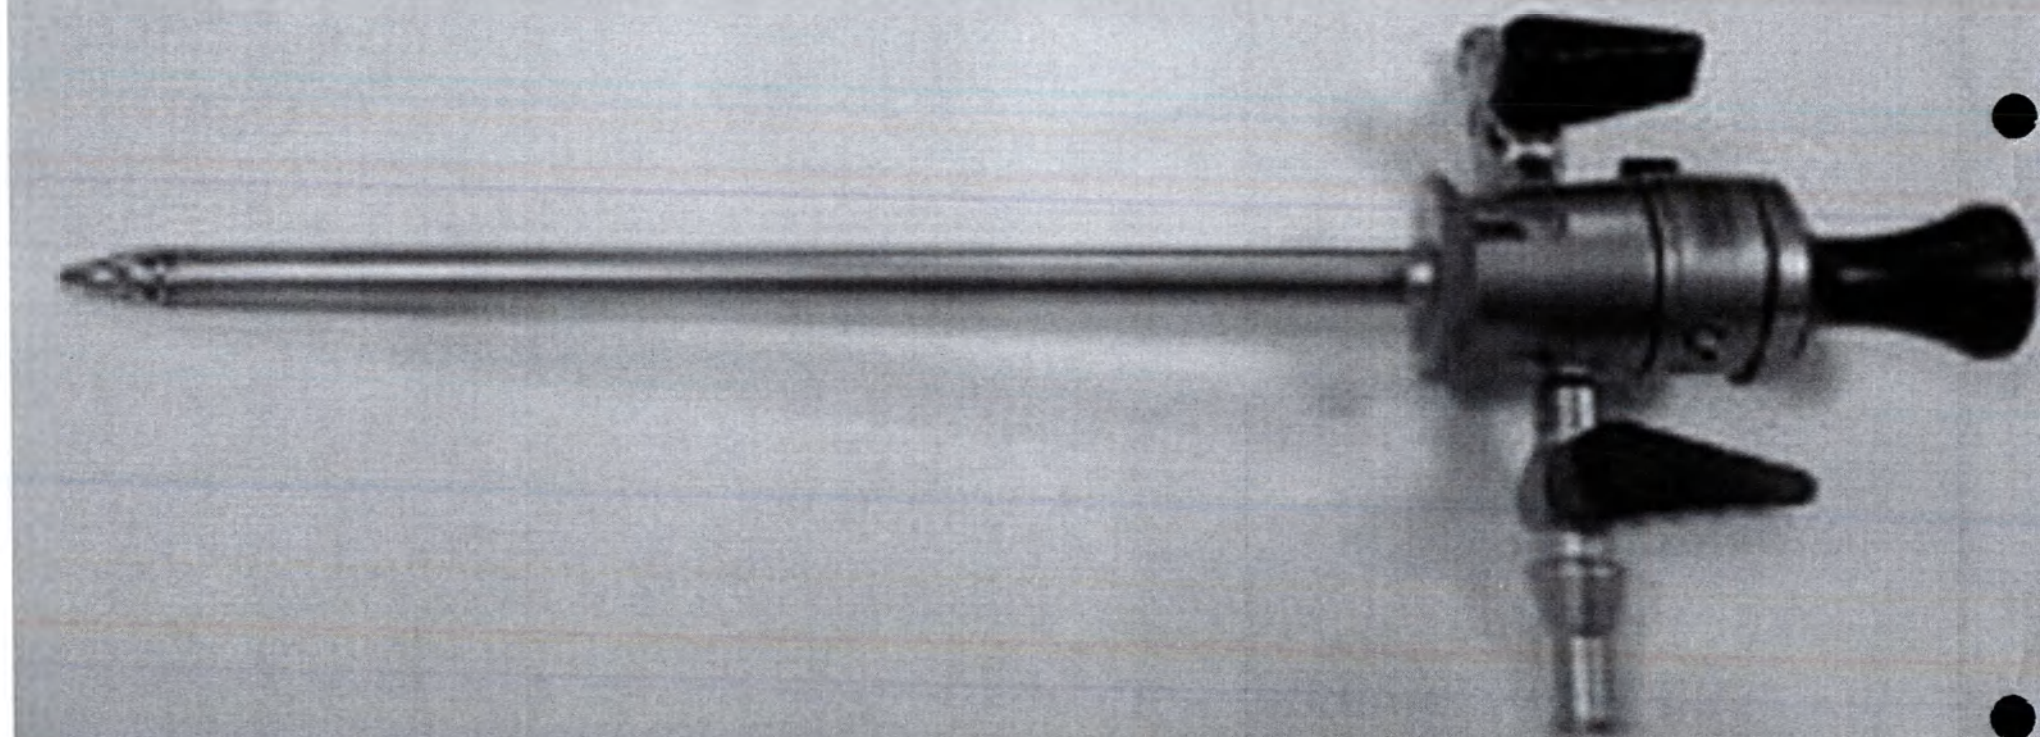

3. Трубка троакарная: A5550, A5560, A5561, A5562, A5815, A5820, A5822, A70976A, WA58142L, WA58149S, WA58169S, WA58189S, WA58241S, WA58242A, WA70050A, WA70051A, WA70052A, WA70070A, WA70071A, WA70076A, WA70077A, WA70990A, WA70991A, WA70992A, WA70993A, WA70994A, WA70995A, WA58023L, WA58022L, WA58023A, WA58022A, WA58025L, WA58024L, WA58025A, WA58024A, A7832, WA58021L,

Трубка троакарная: A5550 (макет маркировки)

Артикул	Трубка троакарная: A5550
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




A 5831

4. Стиллет троакара: WA58011L, WA58007L, WA58011A, WA58006A, WA58007A, WA58012L, WA58014L, WA58012A, WA58013A, WA58014A, A7831, WA58009L, WA58010L, WA58008A, WA58009A, WA58010A, A2248, WA58015A, WA58016A.

Стиллет троакара: WA58011L (макет маркировки)


Артикул	Стиллет троакара: WA58011L
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

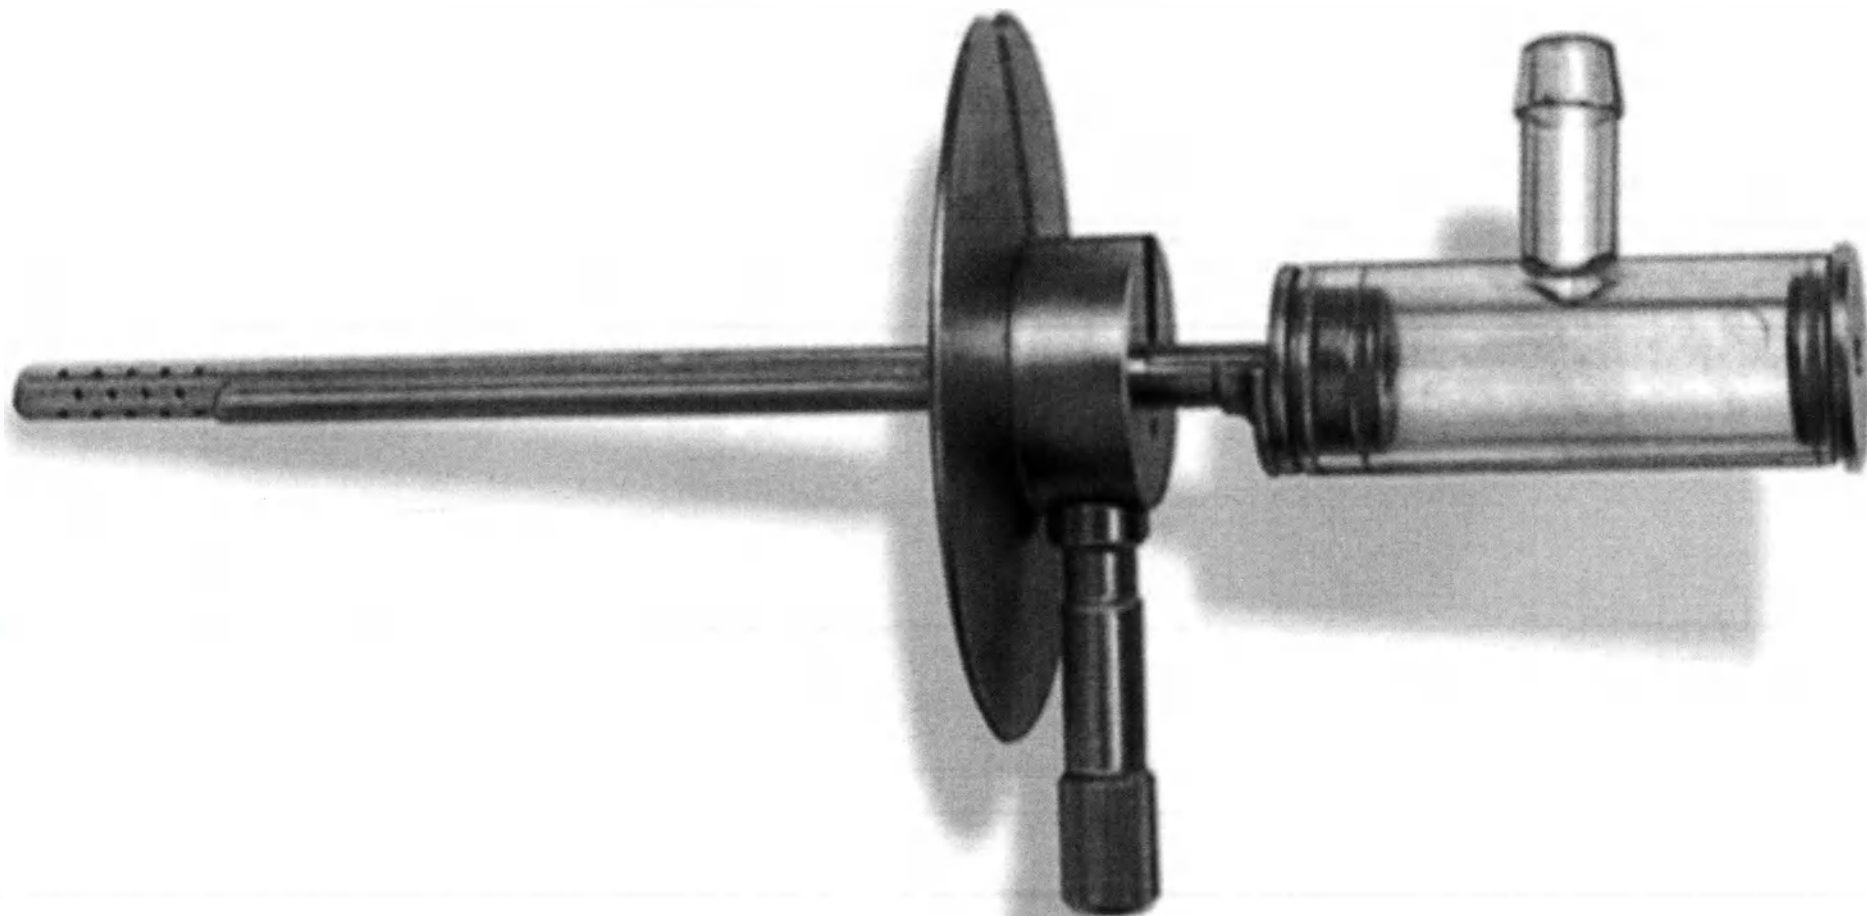

5. Набор для надобкового прокола А2251 в составе: А2246, А2247, А2248, А2249, А2250.

Набор для надлобкового прокола A2251 (макет маркировки)


Артикул	Набор для надлобкового прокола A2251
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

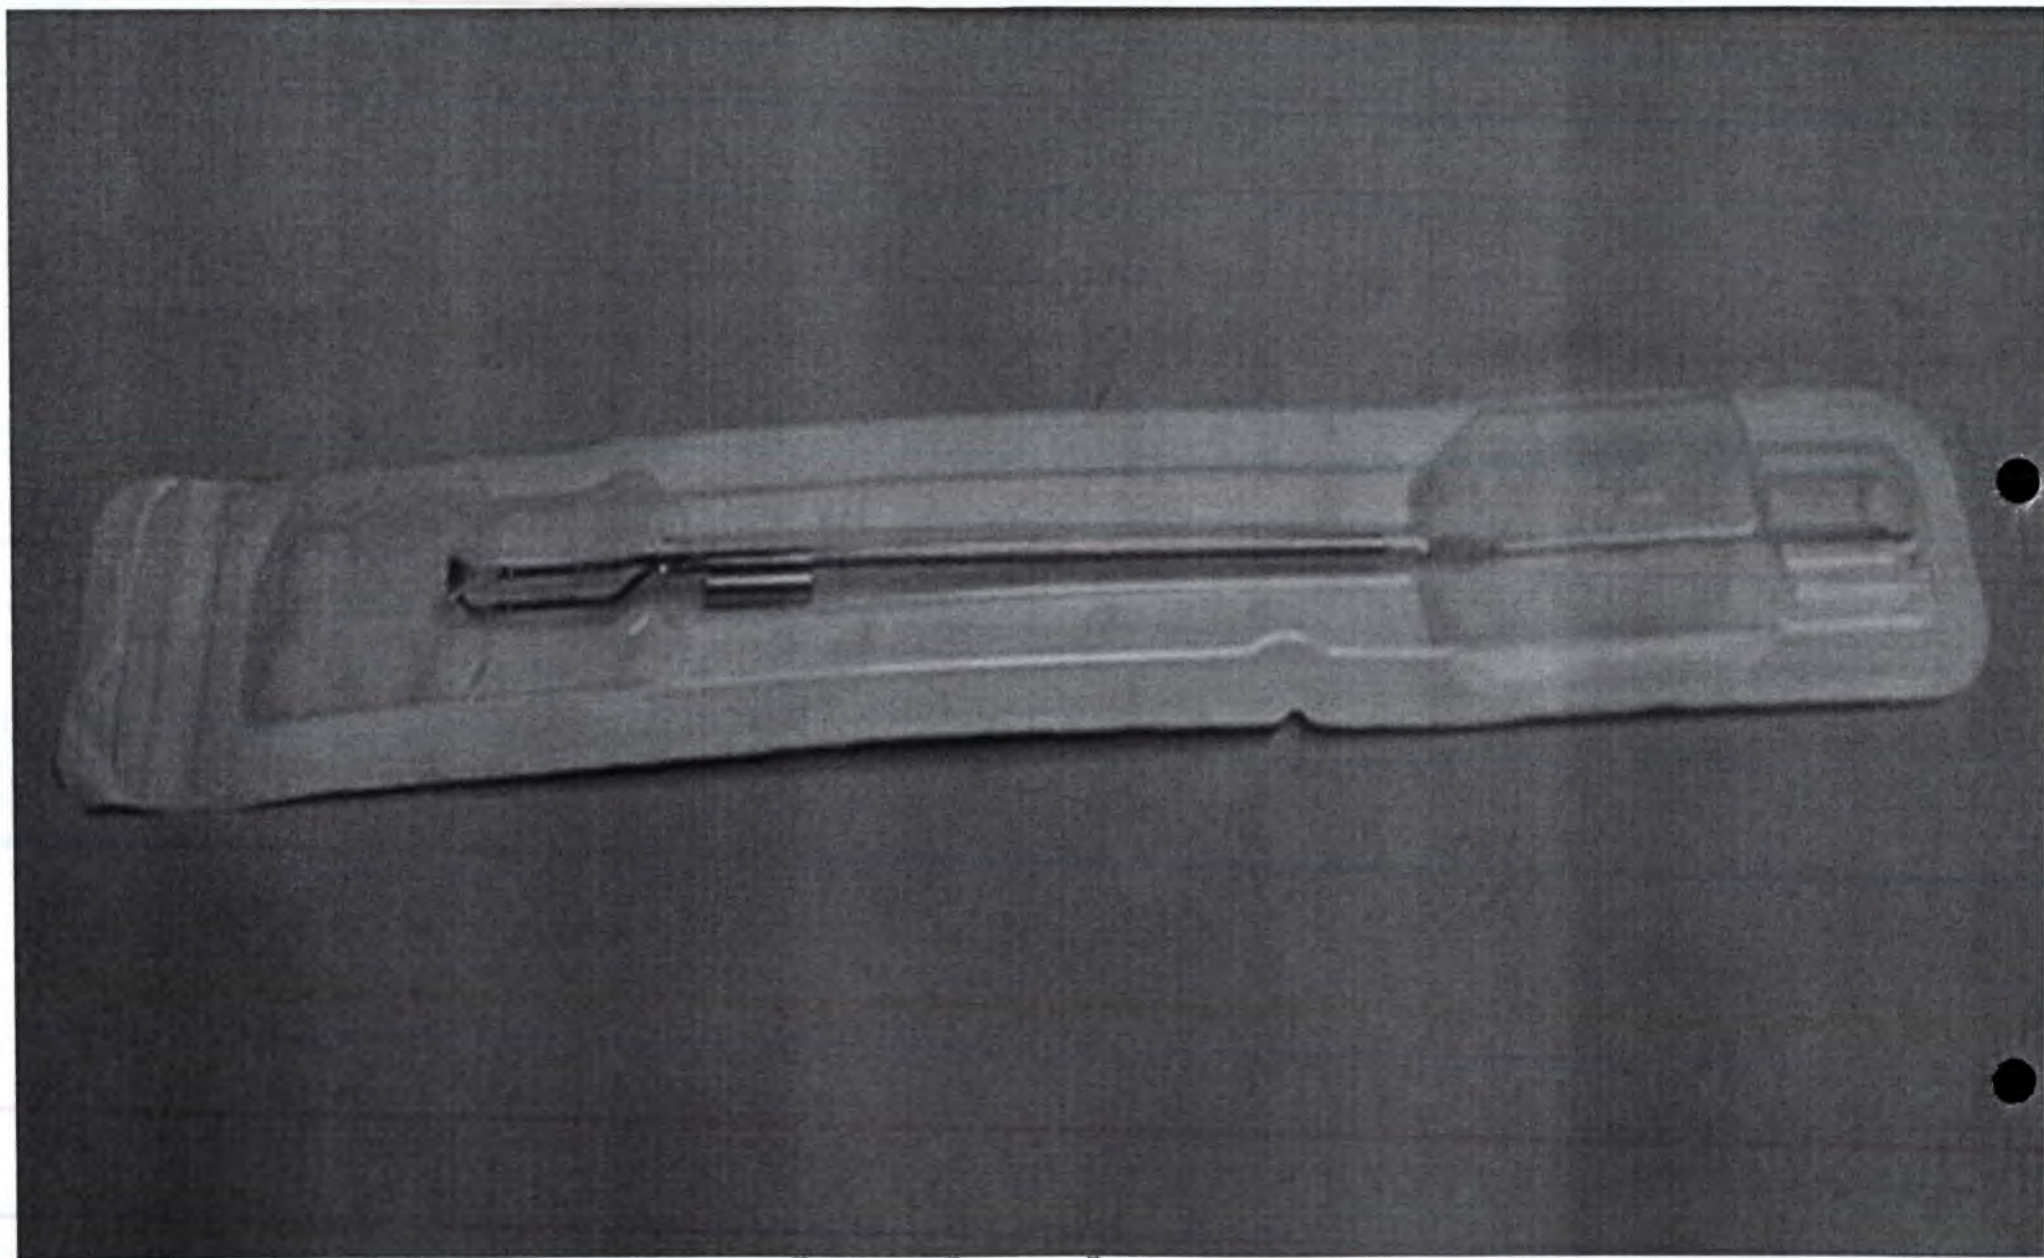


III. ИНСТРУМЕНТЫ РЕЖУЩИЕ И УДАРНЫЕ С ОСТРОЙ (РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ): ВЧ-электрод: A2183, A2189, A2193, A2195, A2203, A39508A, A4513, A4514, A4515, A4728, A4750, A4751, A4752, A4753, A4754, A4755, A4756, A6280, A6281, A6282, A6283, A6284, A6289, A6292, A6293, A6294, A6299, O0107, O0108, O0109, O0110, O0111, O0112, O0113, O0114, O0115, O3461, WA22037A, WA22037C, WA22038A, WA22038C, WA22039A, WA22039C, WA22200D, WA22204D, WA22208D, WA22209D, WA22232D, WA22233D, WA22301D, WA22302D, WA22305D, WA22306D, WA22331D, WA22332D, WA22351A, WA22351C, WA22355A, WA22355C, WA47050A, WA47050C, WA47051A, WA47051C, WA47052A, WA47052C, WA47053A, WA47053C, WA47054A, WA47054C, WA47055C, WA47056C, A2583, A2425, A0275, A2426, A2664, A3184, A3756, A22250C, A3189, A3183, A3753, A3188, A3755, A3813, A22202B,

ВЧ-электрод: A2183 (макет маркировки)

Артикул	ВЧ-электрод: A2183
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

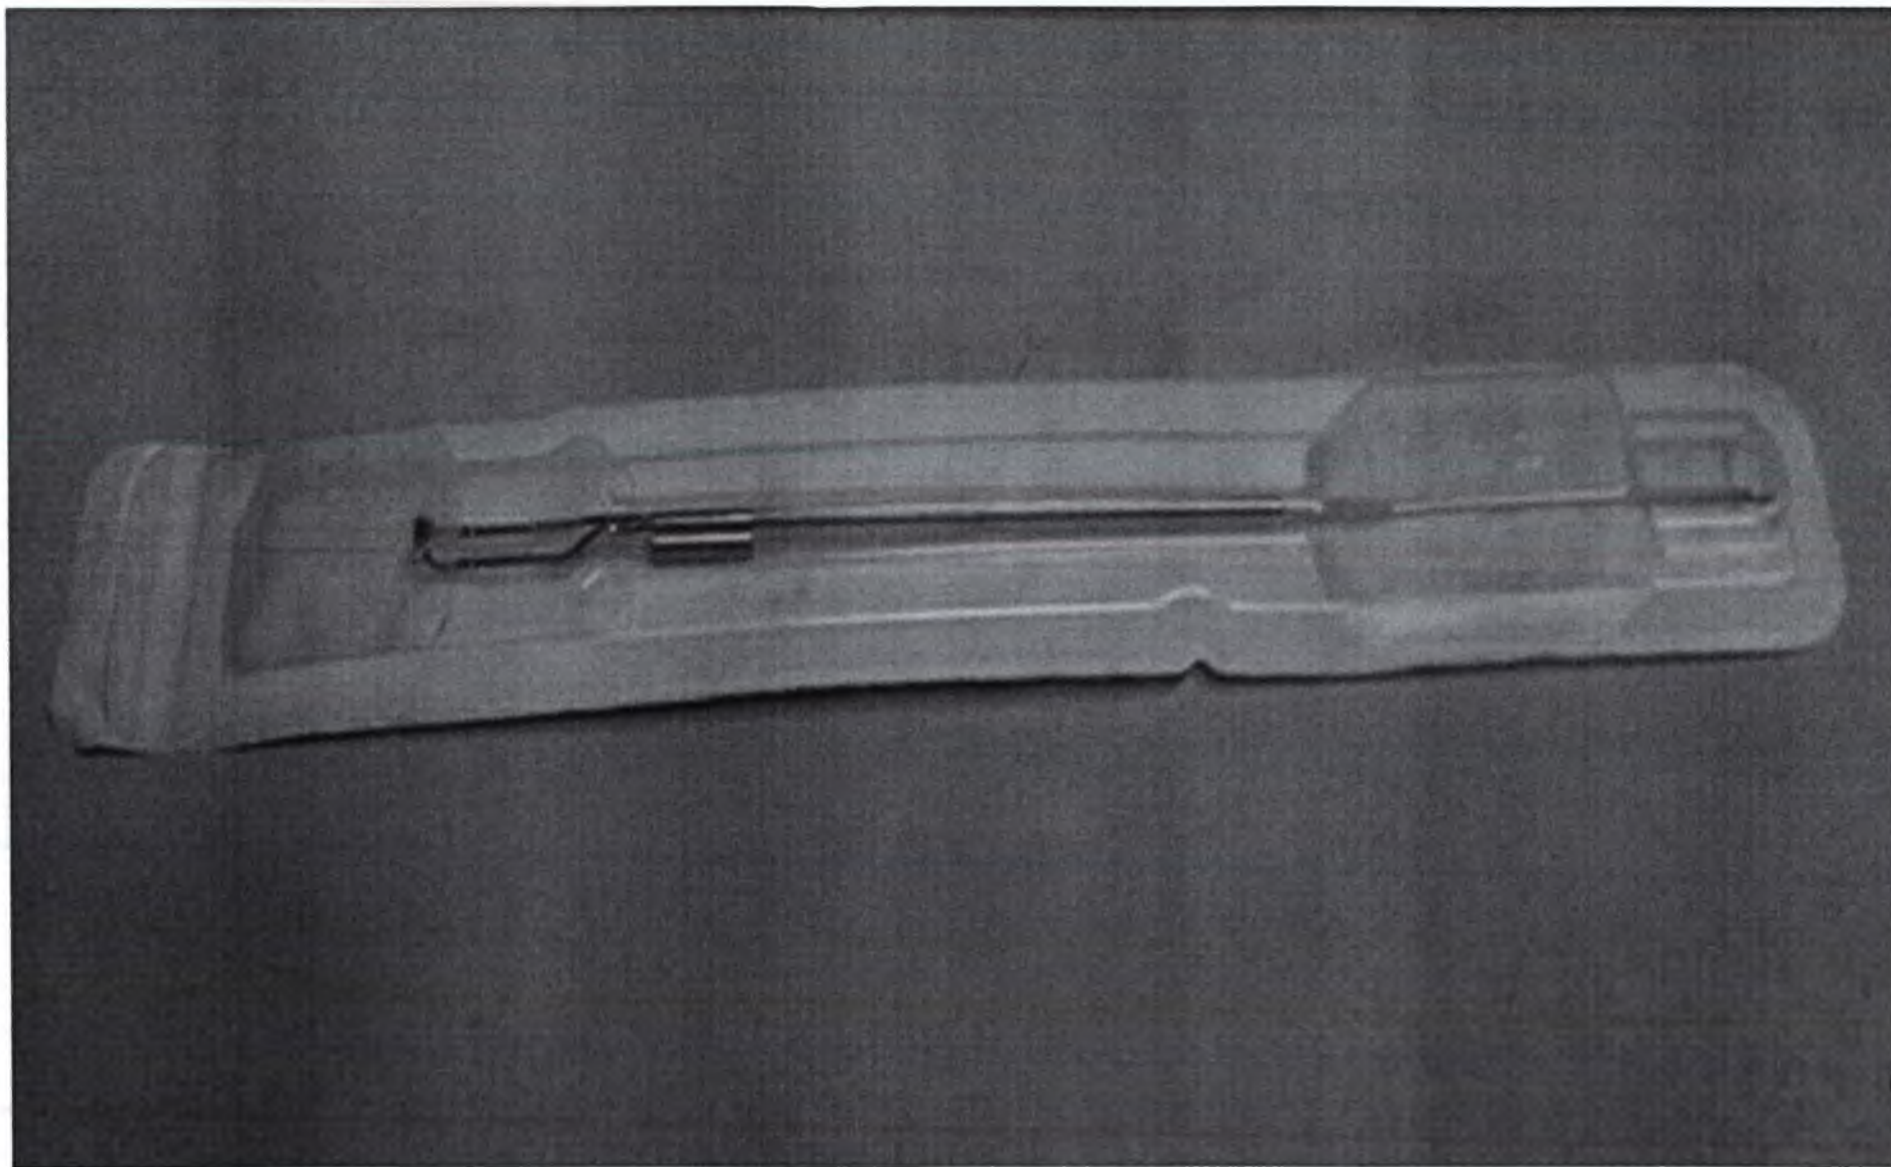

A22202D, A22203B, A22203D, A22206B, A22206D, A22207B, A22207D, A22250A, A22250C, A22257D, A22266A, WA22201R, WA22201S, WA22202R, WA22202S, WA22203R, WA22203S, WA22210R, WA22210S, WA22211R, WA22211S, WA22221S, WA22222S, WA22302S, WA22306S, WA22331D, WA22332S, WA22351R, WA22351S, WA22355R, WA22355S, WA22503D, WA22503S, WA22507D, WA22507S, WA22521C, WA22521S, WA22523C, WA22523S, WA22536S, WA22537D, WA22537S, WA22538A, WA22538C, WA22538R, WA22538S, WA22539D, WA22539S, WA22557C, WA22557S, WA22558C, WA22558S, WA22559S, WA22757S, WA47050R, WA47050S, WA47051R, WA47051S, WA47052R, WA47052S, WA47053R, WA47053S, WA47054R, WA47054S, WA47055S, WA47056C, WA47056S, WABD09MS, WABD10MS, WACL21MS, WACL27MS, WACL28MS, WALP01MR,

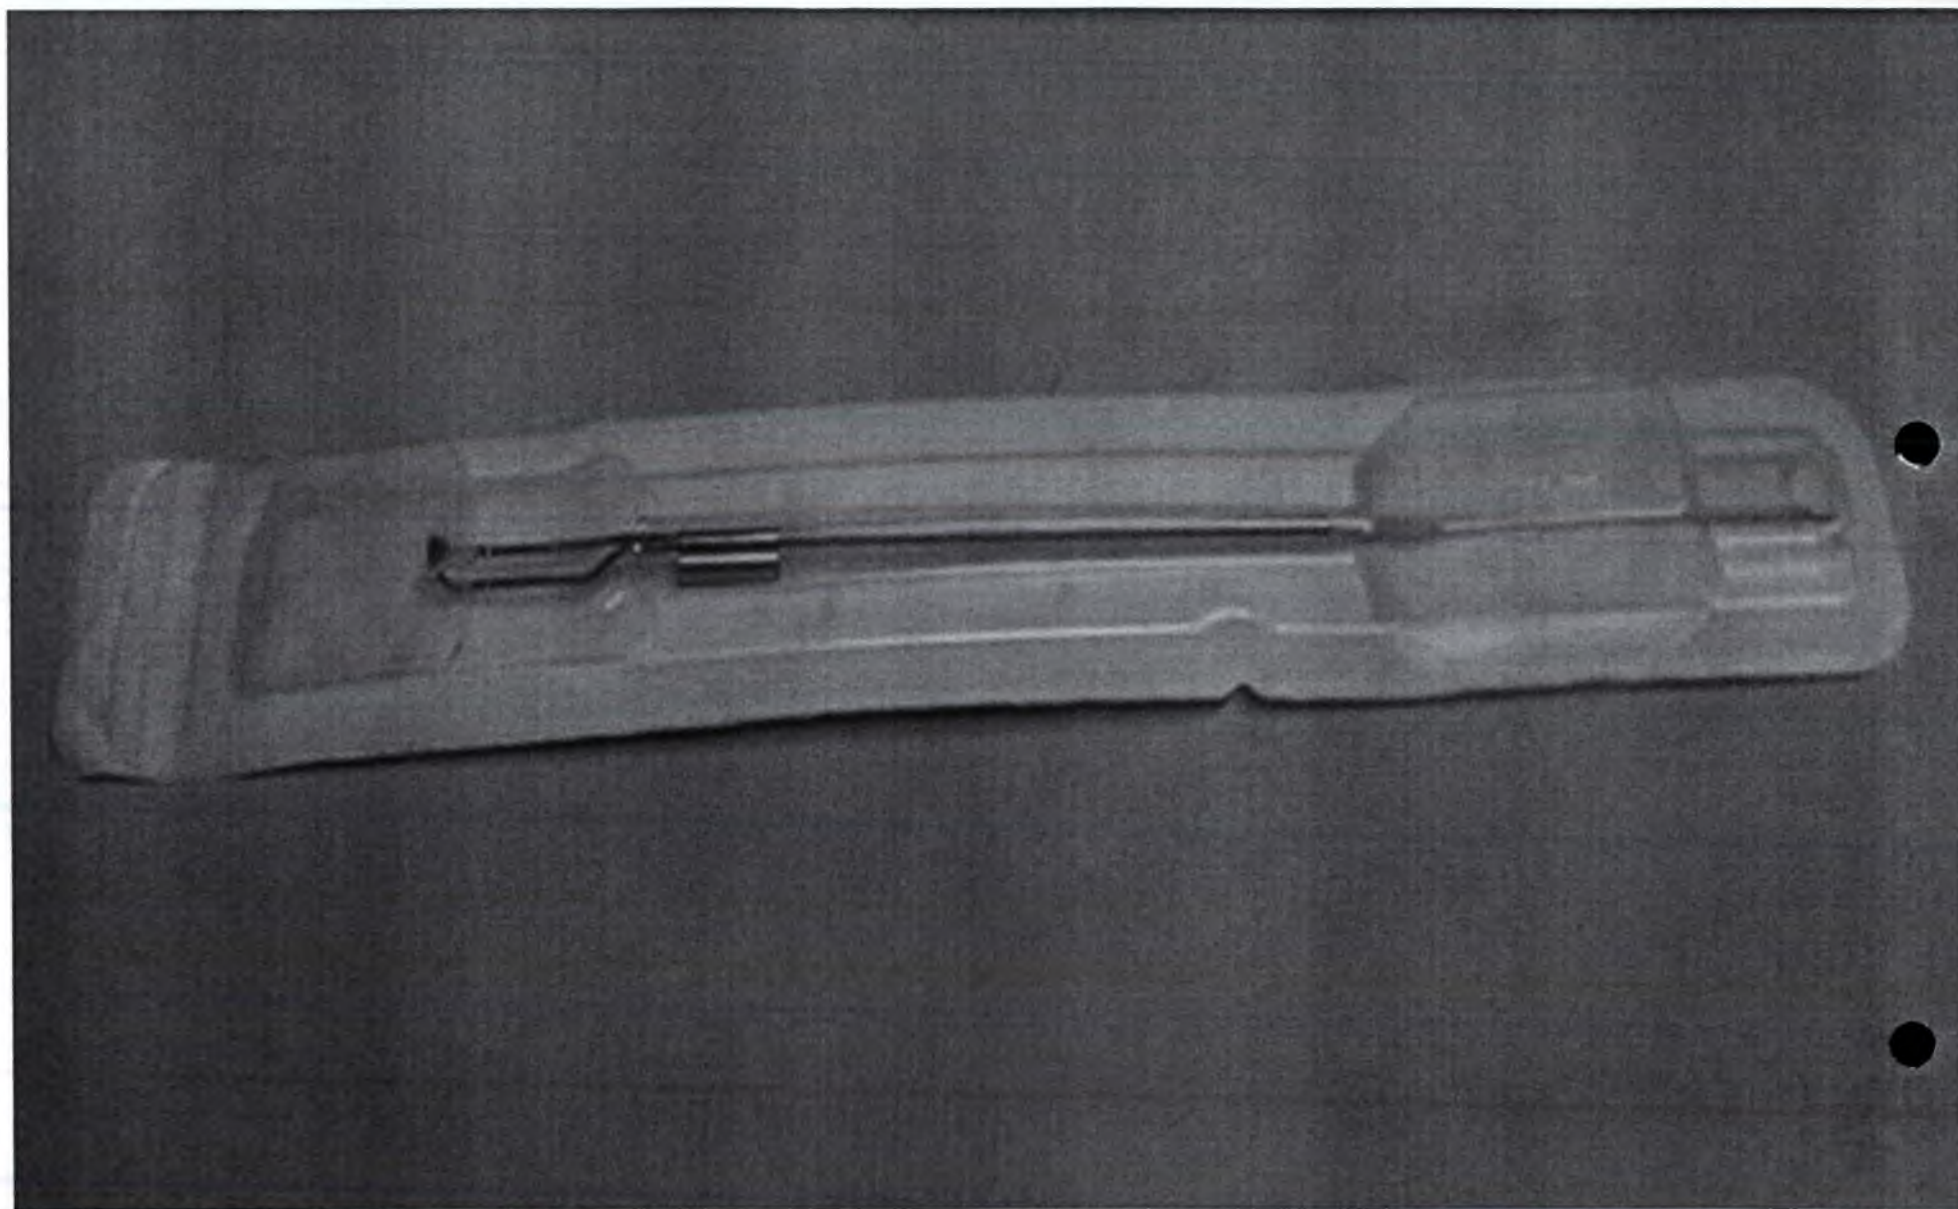

WALP02MR, WALP03MS, WALP04MS, WALP05MR, WALP06MS, WALP07MR, WALP08MS, WALP11MR, WALP12MR, WALP13MS, WALP14MS, WALP30MR, WALP31MS, WALP34MR, WALP35MS, WAND17MR, WAND18MS, WAND19MR, WAND20MS, WARL15MR, WARL16MS, WARL22MR, WARL23MS, WARL32MR, WARL33MS, WARN24MR, WARN25MS, WA22543S, WA47505S, WA47506S, WA47507S, WA47540S, WA47551S, WA47555S, WA47560S, WA47566S, WA22705S, WA47705S, WA22740S, WA47740S, WA22744S, WA47744S, WA22766S, WA47766S, WA22742S, WA47742S, WA22743S, WA47743S, WA22741S,




A 37008 A

2. Ножи: O2160, O2162, O3524, O3525, O3526, A7685, A7695, A7684, WA35055A, WA35057A, A7850, A7683, A7690, A7694, A7686, A7691, A3557, A3577, A2588, A2587, A2589, A3749, A3555, A3575, A3187, A2497, A3556, A3576, A3559, A3599, A3186, A3558, A3574, A3748, A7855, A7856, A7854, A7434, A7444, A7450, A7421, A7431, A7433, A7443, A7430, A7440, A7437, A7447, A7426, A7436, A22265C, A3328, A3329, A37008A, A37009A, A37010A.

Ножи: O2160 (макет маркировки)

Артикул	Ножи: O2160
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

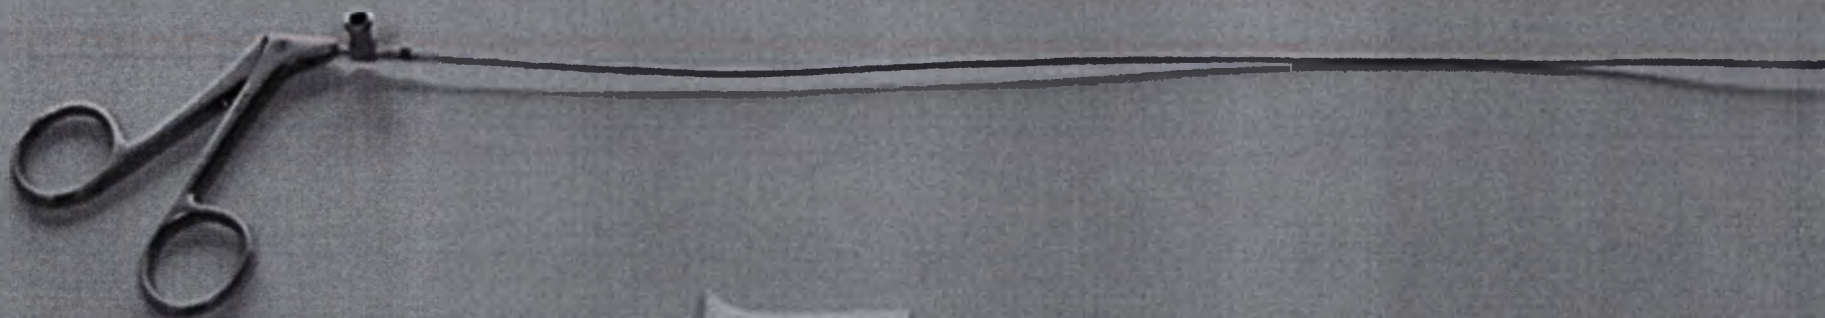


A 4820

- Ножницы: A5861, O0129, A5763, A7863, A7864, A7865, A4617, A2576, A2578, A4826, A4828, A4830, A4833,
A69070I, WA69070M, WA69072L, WA69072M, WA69074L, WA69074M, WA69076L, WA69076M.

Ножницы: А5861(макет маркировки)

Артикул	Ножницы: А5861
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

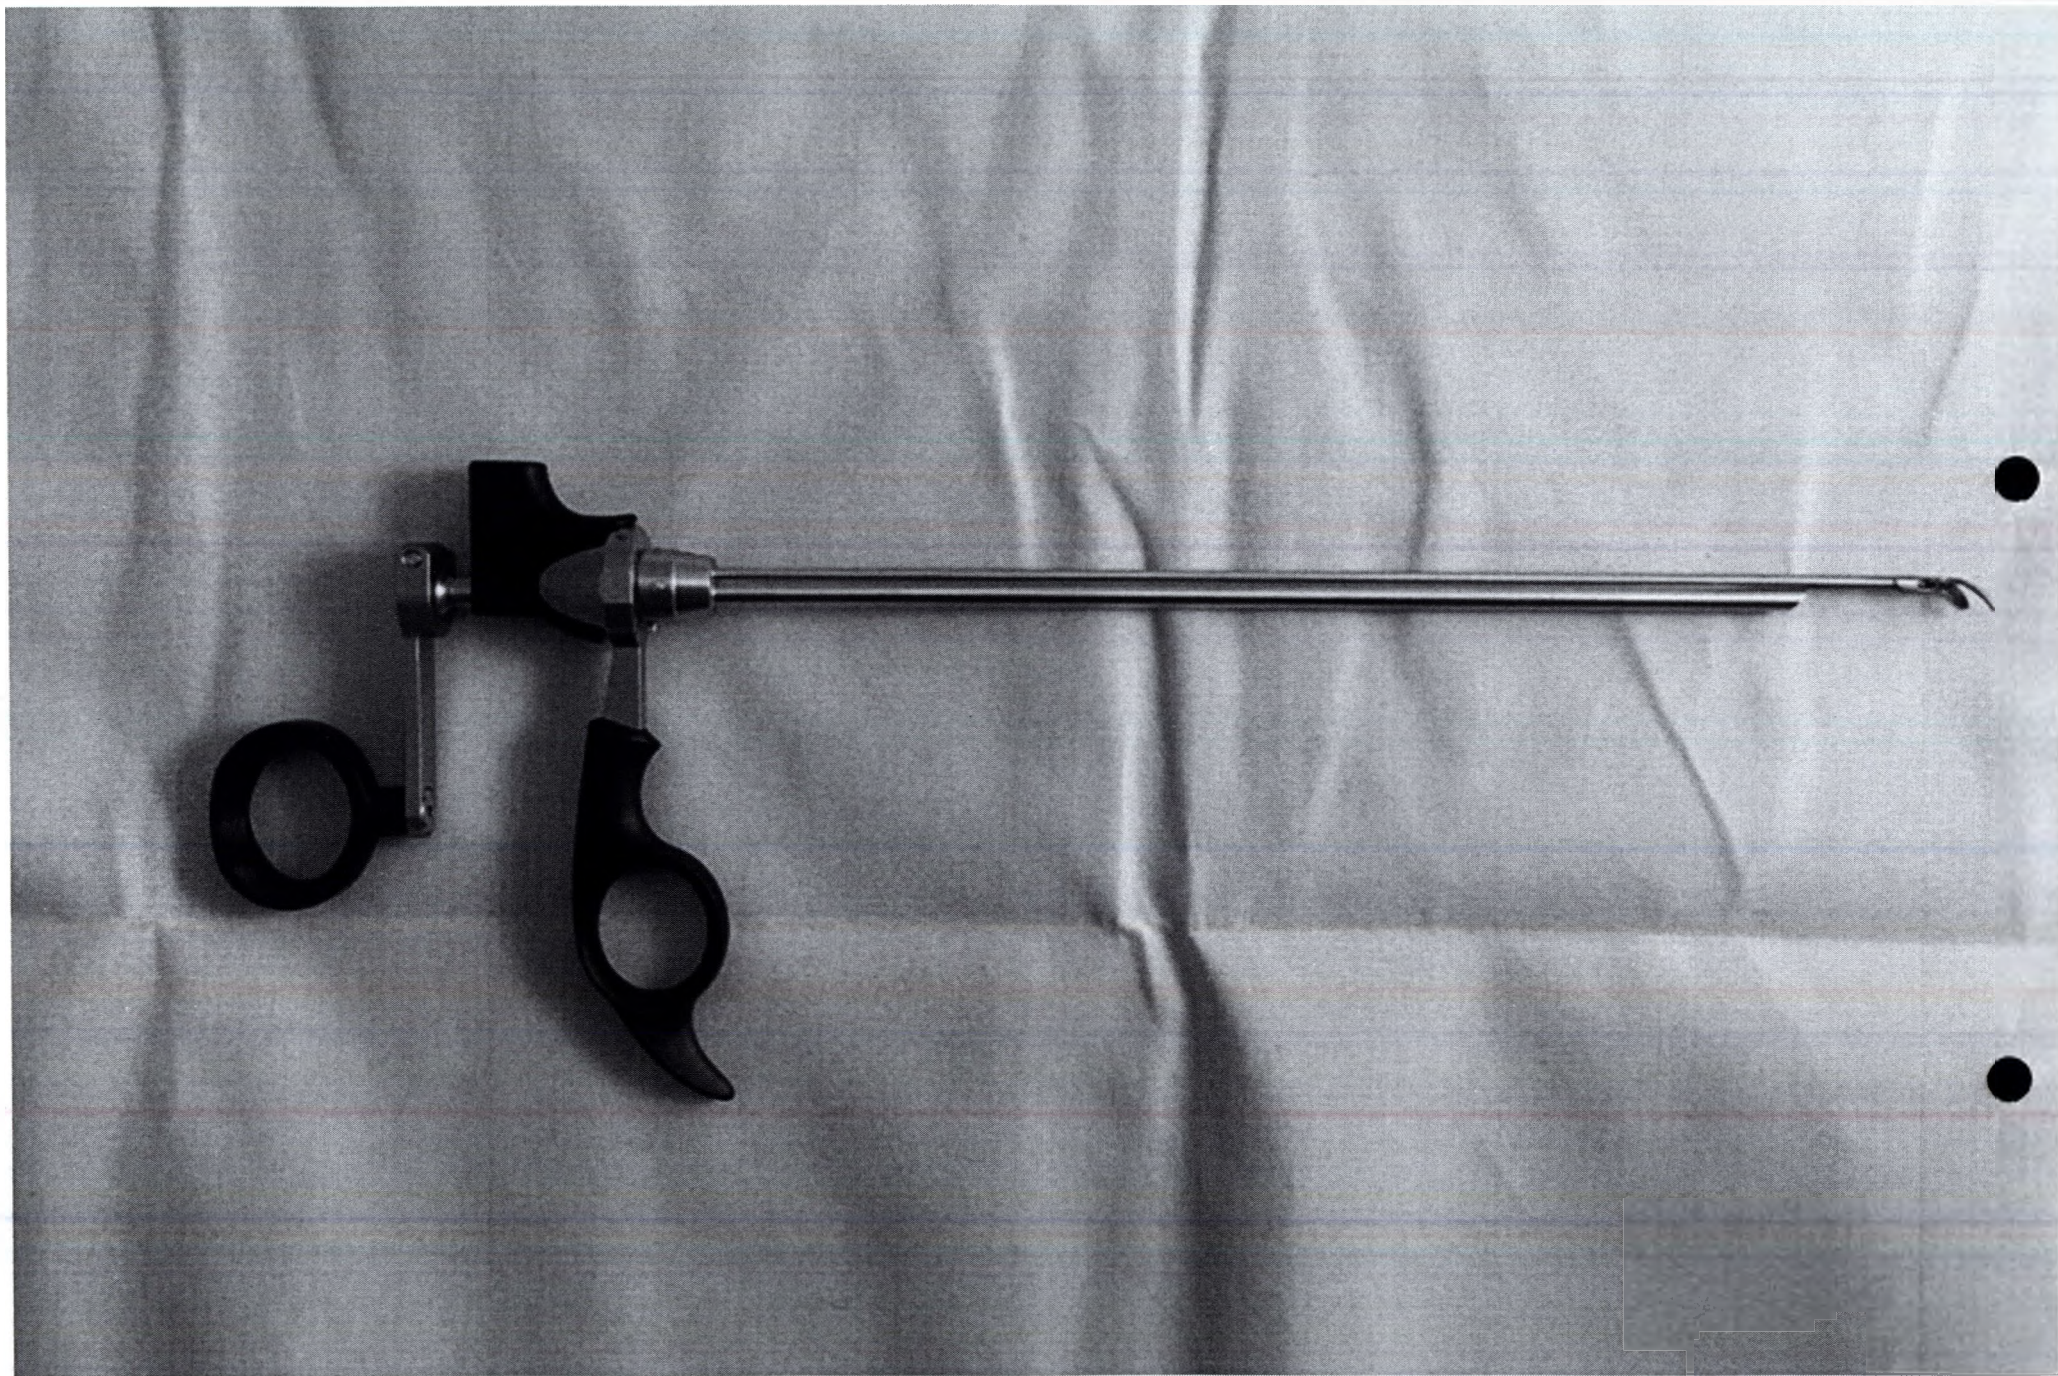

Ножницы, оптические: A4678, A20717A.

Ножницы, оптические: А4678 (макет маркировки)

Артикул	Ножницы, оптические: А4678
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




- Ножницы ультразвуковые (ультразвуковой инструмент Sonicbeat): SB-0520FC, SB-0545FC, SB-0535FC.

Ножницы ультразвуковые (ультразвуковой инструмент Sonicbeat): SB-0520FC (макет маркировки)

Артикул	Ножницы ультразвуковые (ультразвуковой инструмент Sonicbeat): SB-0520FC
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электровзаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Рабочий элемент: А4743, А4744, А4745, WA22066А, WA22366А, А3550, WA22067А, WA22367А, А37005А, А37014А.

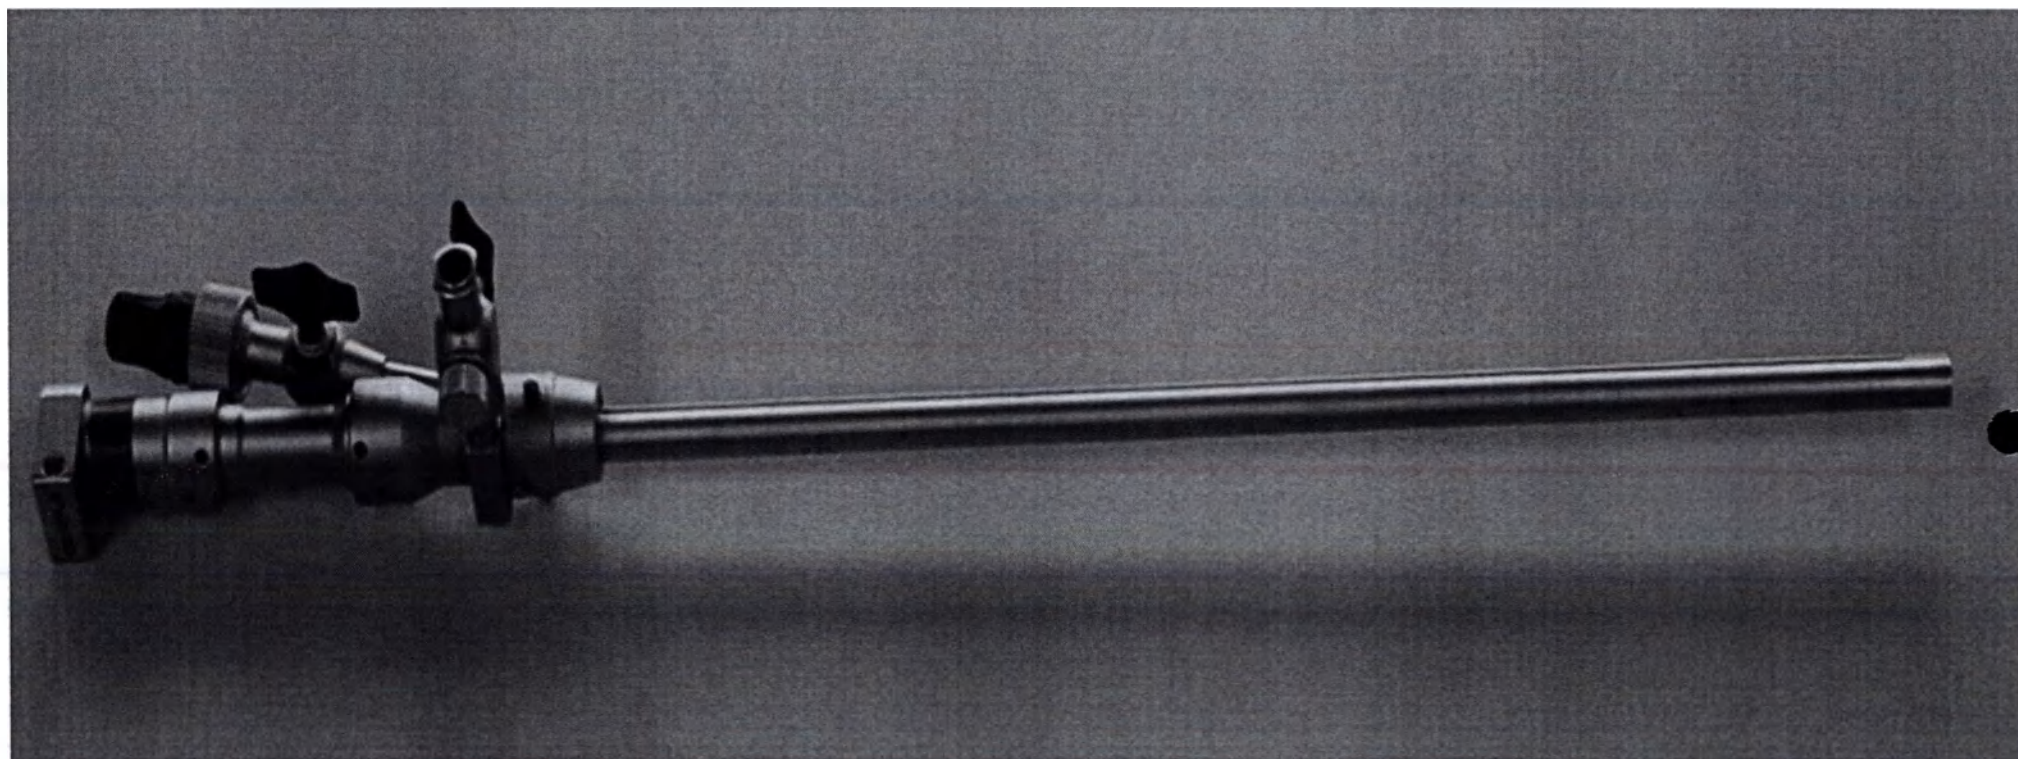


Рабочий элемент: А4764 (макет маркировки)

Артикул	Рабочий элемент: А4764
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Ручки: A60210A (макет маркировки)


Артикул	Ручки: A60210A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

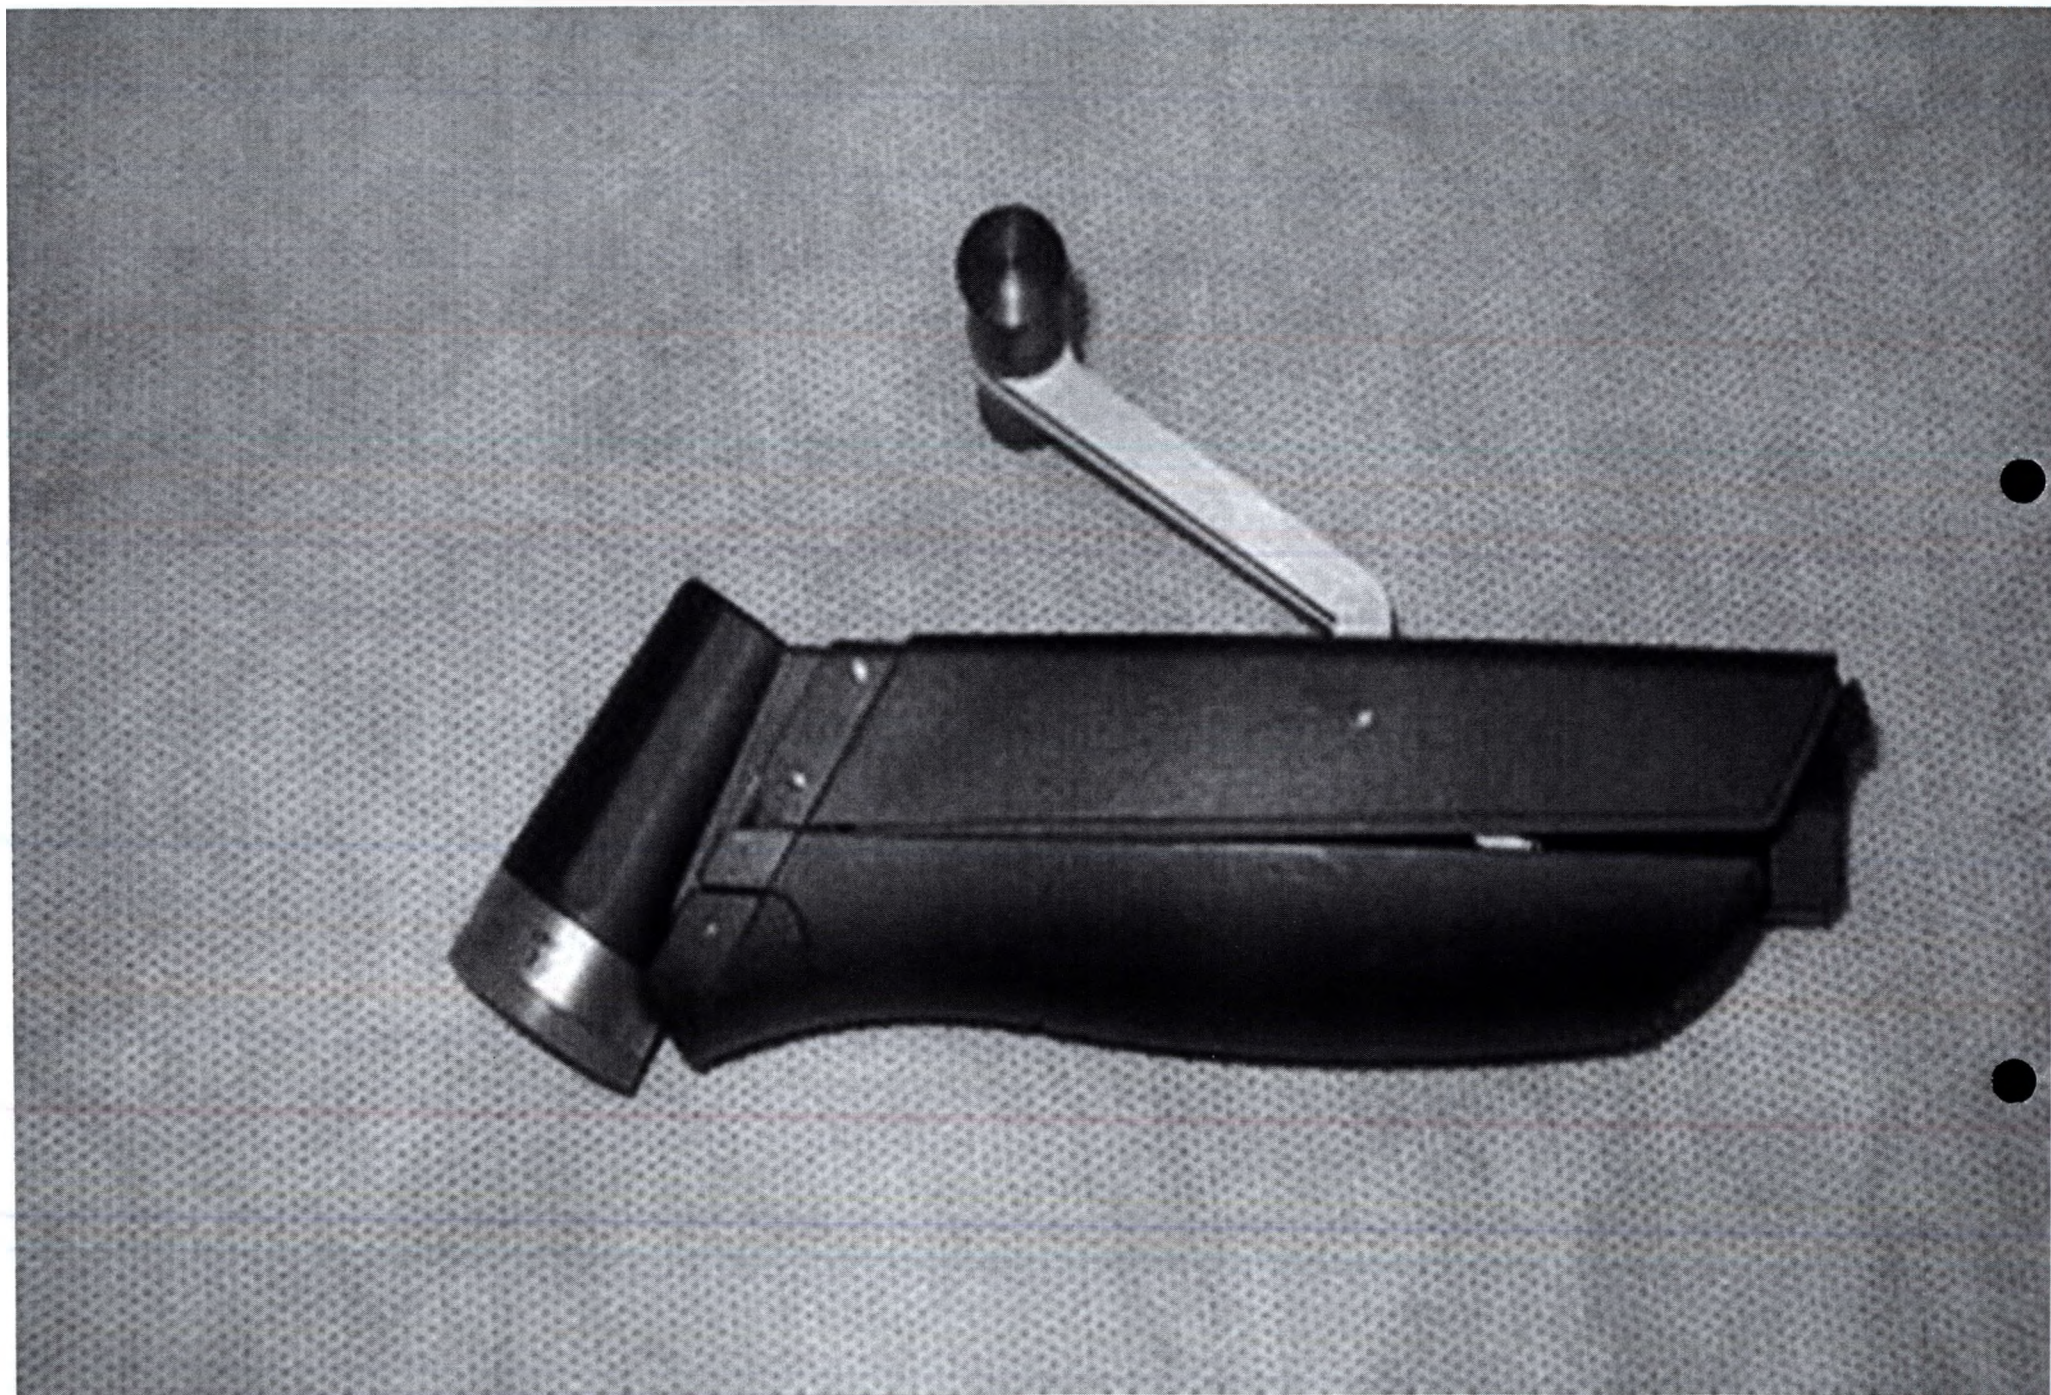

Ручка для инструмента: WA51172A, WA51172L, WA51172S, WA51173A, WA51173L, WA51173S, WA60120A, WA60103A, WA60101C, WA39022A,

Ручка для инструмента: WA51172A (макет маркировки)

Артикул	Ручка для инструмента: WA51172A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

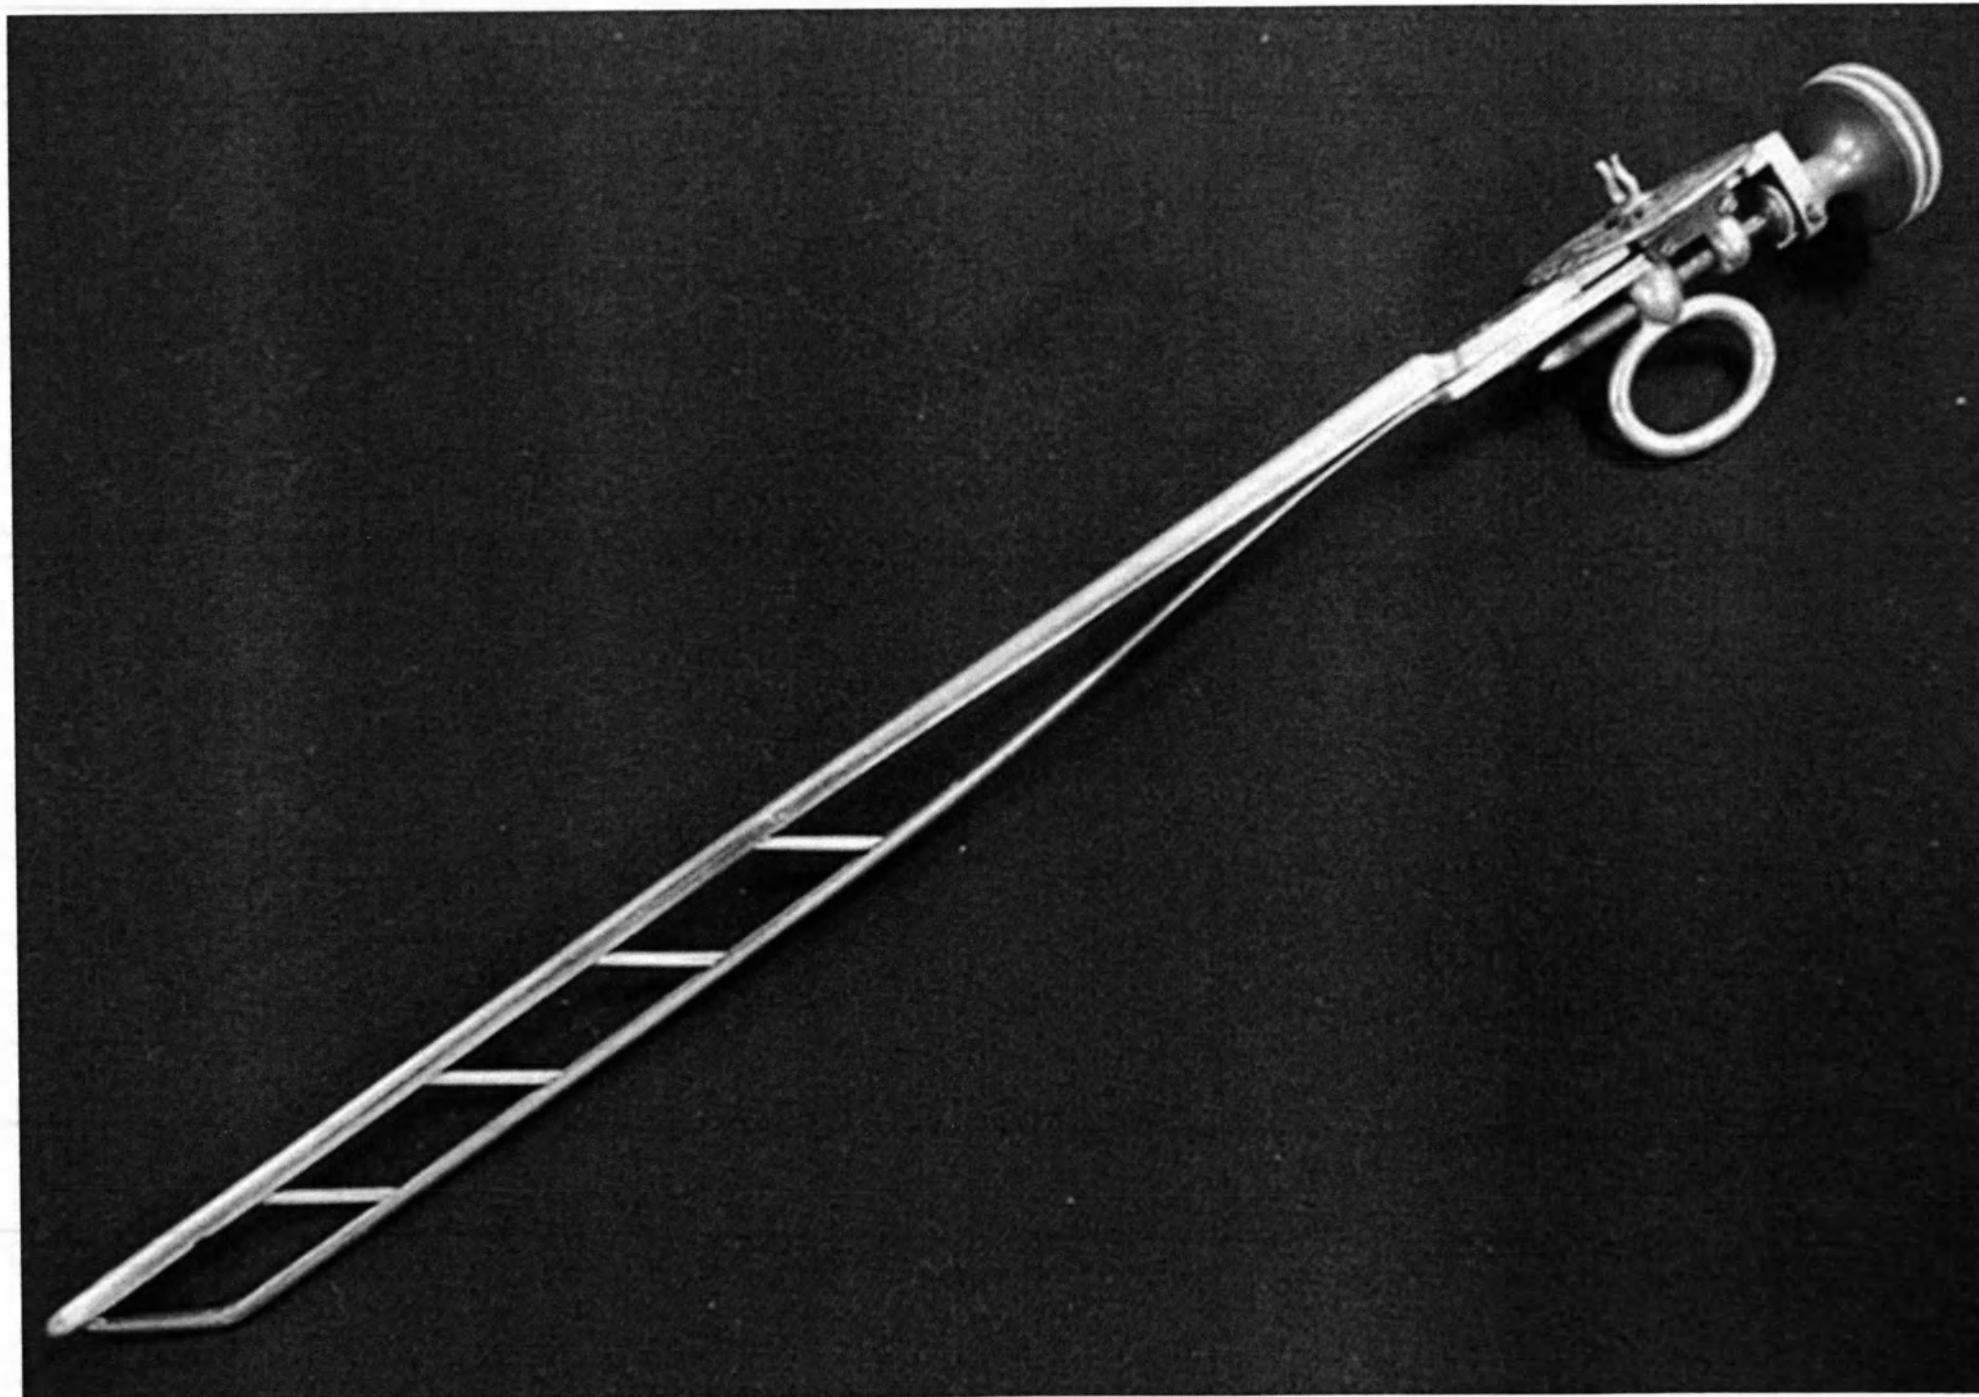

Уретеротом: O0216.

Уретеротом: О0216. (макет маркировки)


Артикул	Уретеротом: О0216
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Электроды биполярные: WB990004, WB990007, WB990008, WB990072, WB990091, WB990092, WB990095, WB990104, WB990105, WB990106, WB990129, WB990136, WB990146, WB990147, WB990148, WB990149, WB990150, WB990151, WB990152, WB990153, WB990162, WB990163, WB990164, WB990165, WB990166, WB990167, WB990168, WB990169, WB990174, WB990175, WB990177, WB990187, WB990188, WB990206, WB990207

Электроды биполярные: WB990004 (макет маркировки)

Артикул	Электроды биполярные: WB990004
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

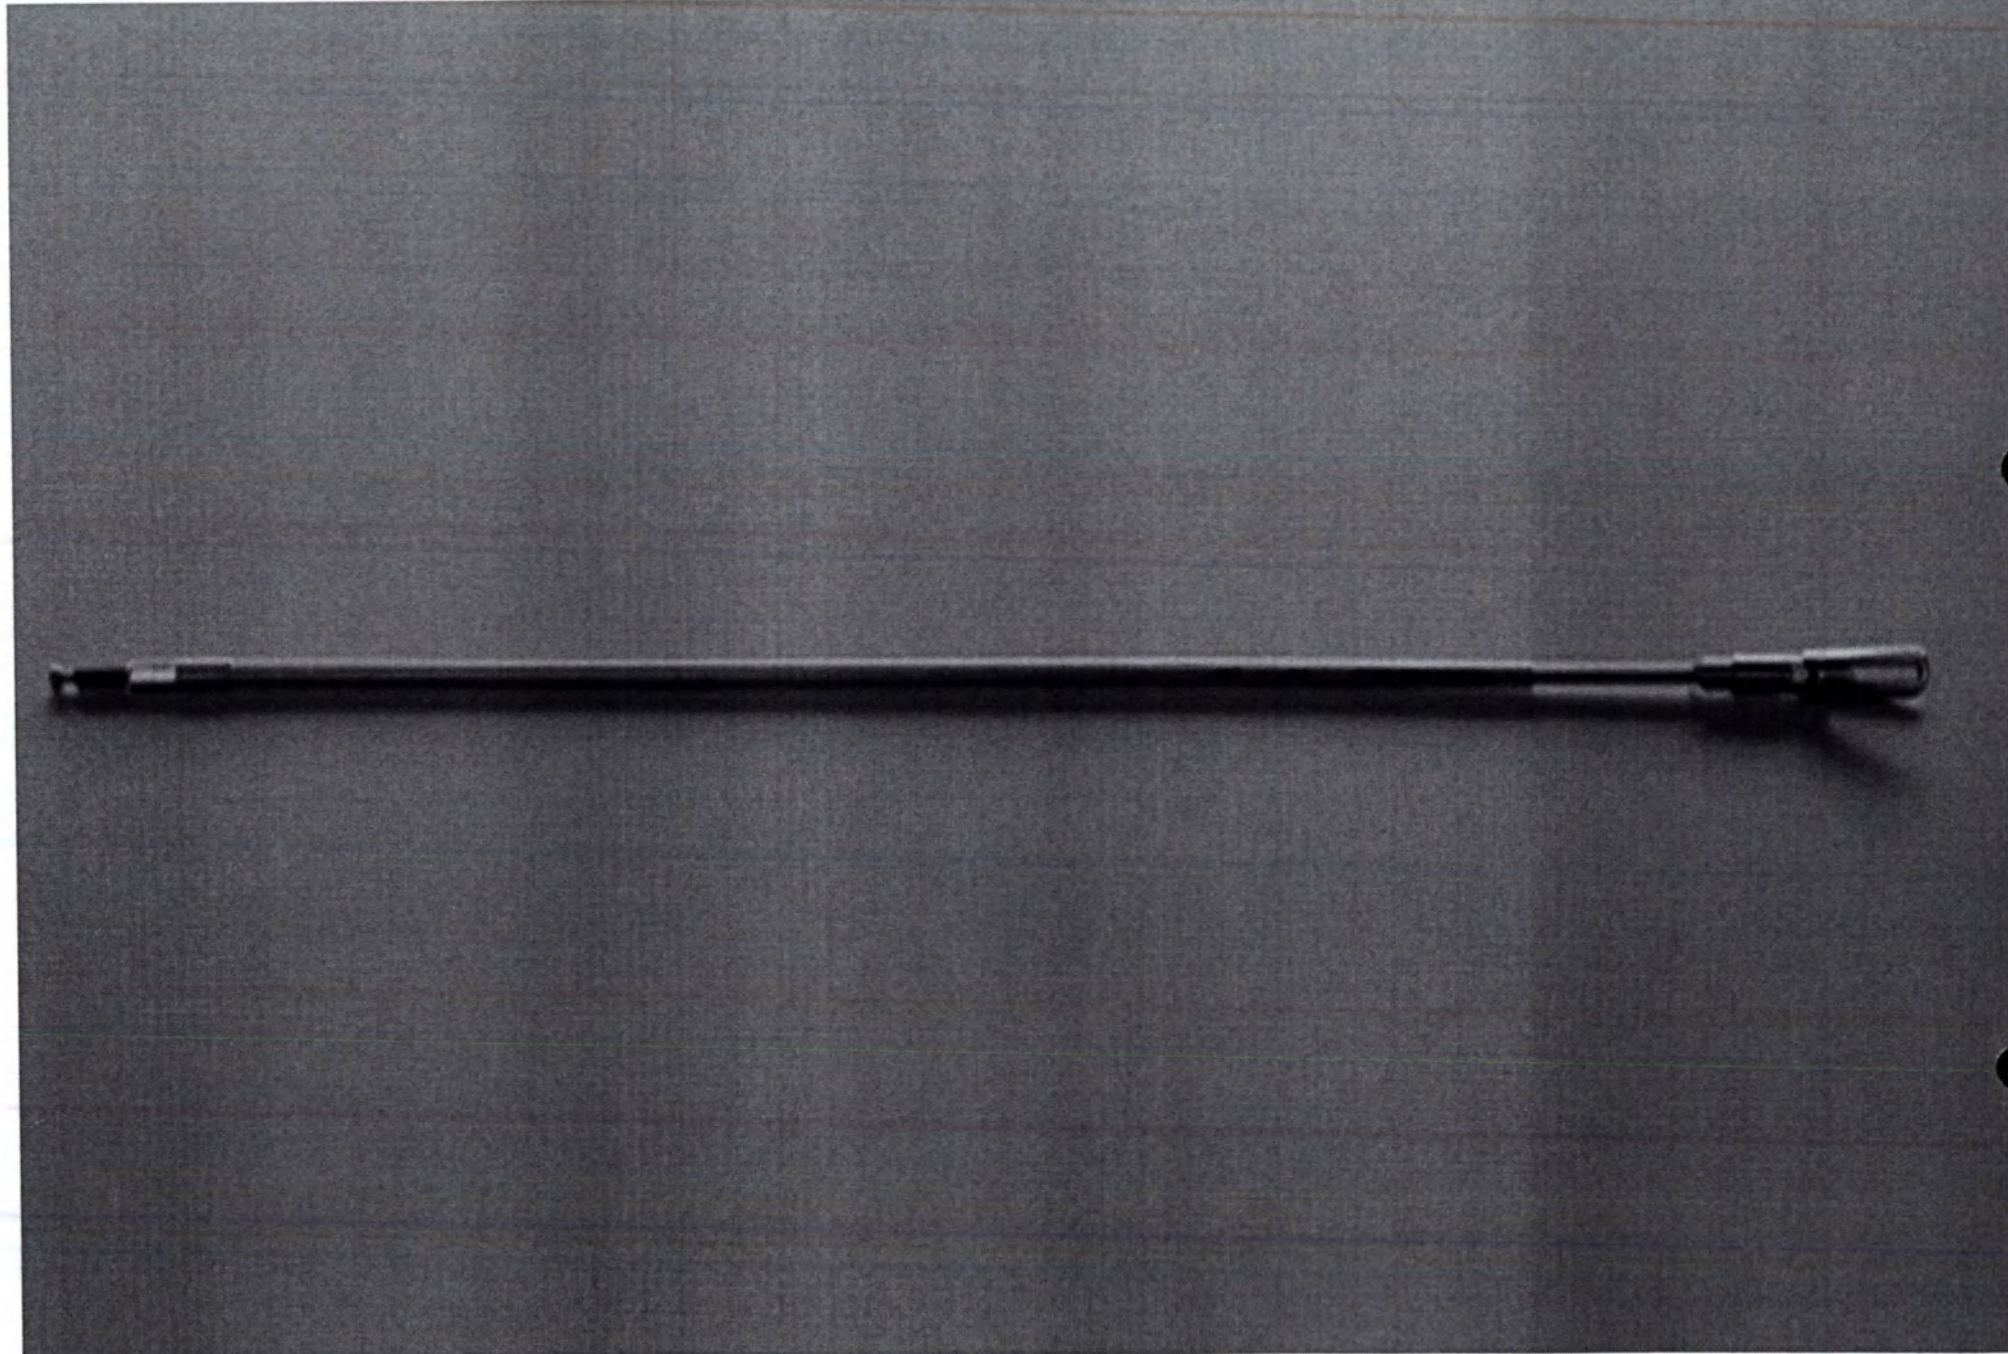

IV. ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЖИМНЫЕ:

Зажим: A5381, A5383, A5387, A5389, A5391, WA64120L, WA64130A, WA64140A, WA64330A, WA64700A, WA64710A, WA64720A, WA64790A,

WA66010A

Зажим: А5381 (макет маркировки)


Артикул	Зажим: А5381
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




Кювета: A7687, A22261A.

Кюрета: А7687 (макет маркировки)

Артикул	Кюрета: А7687
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

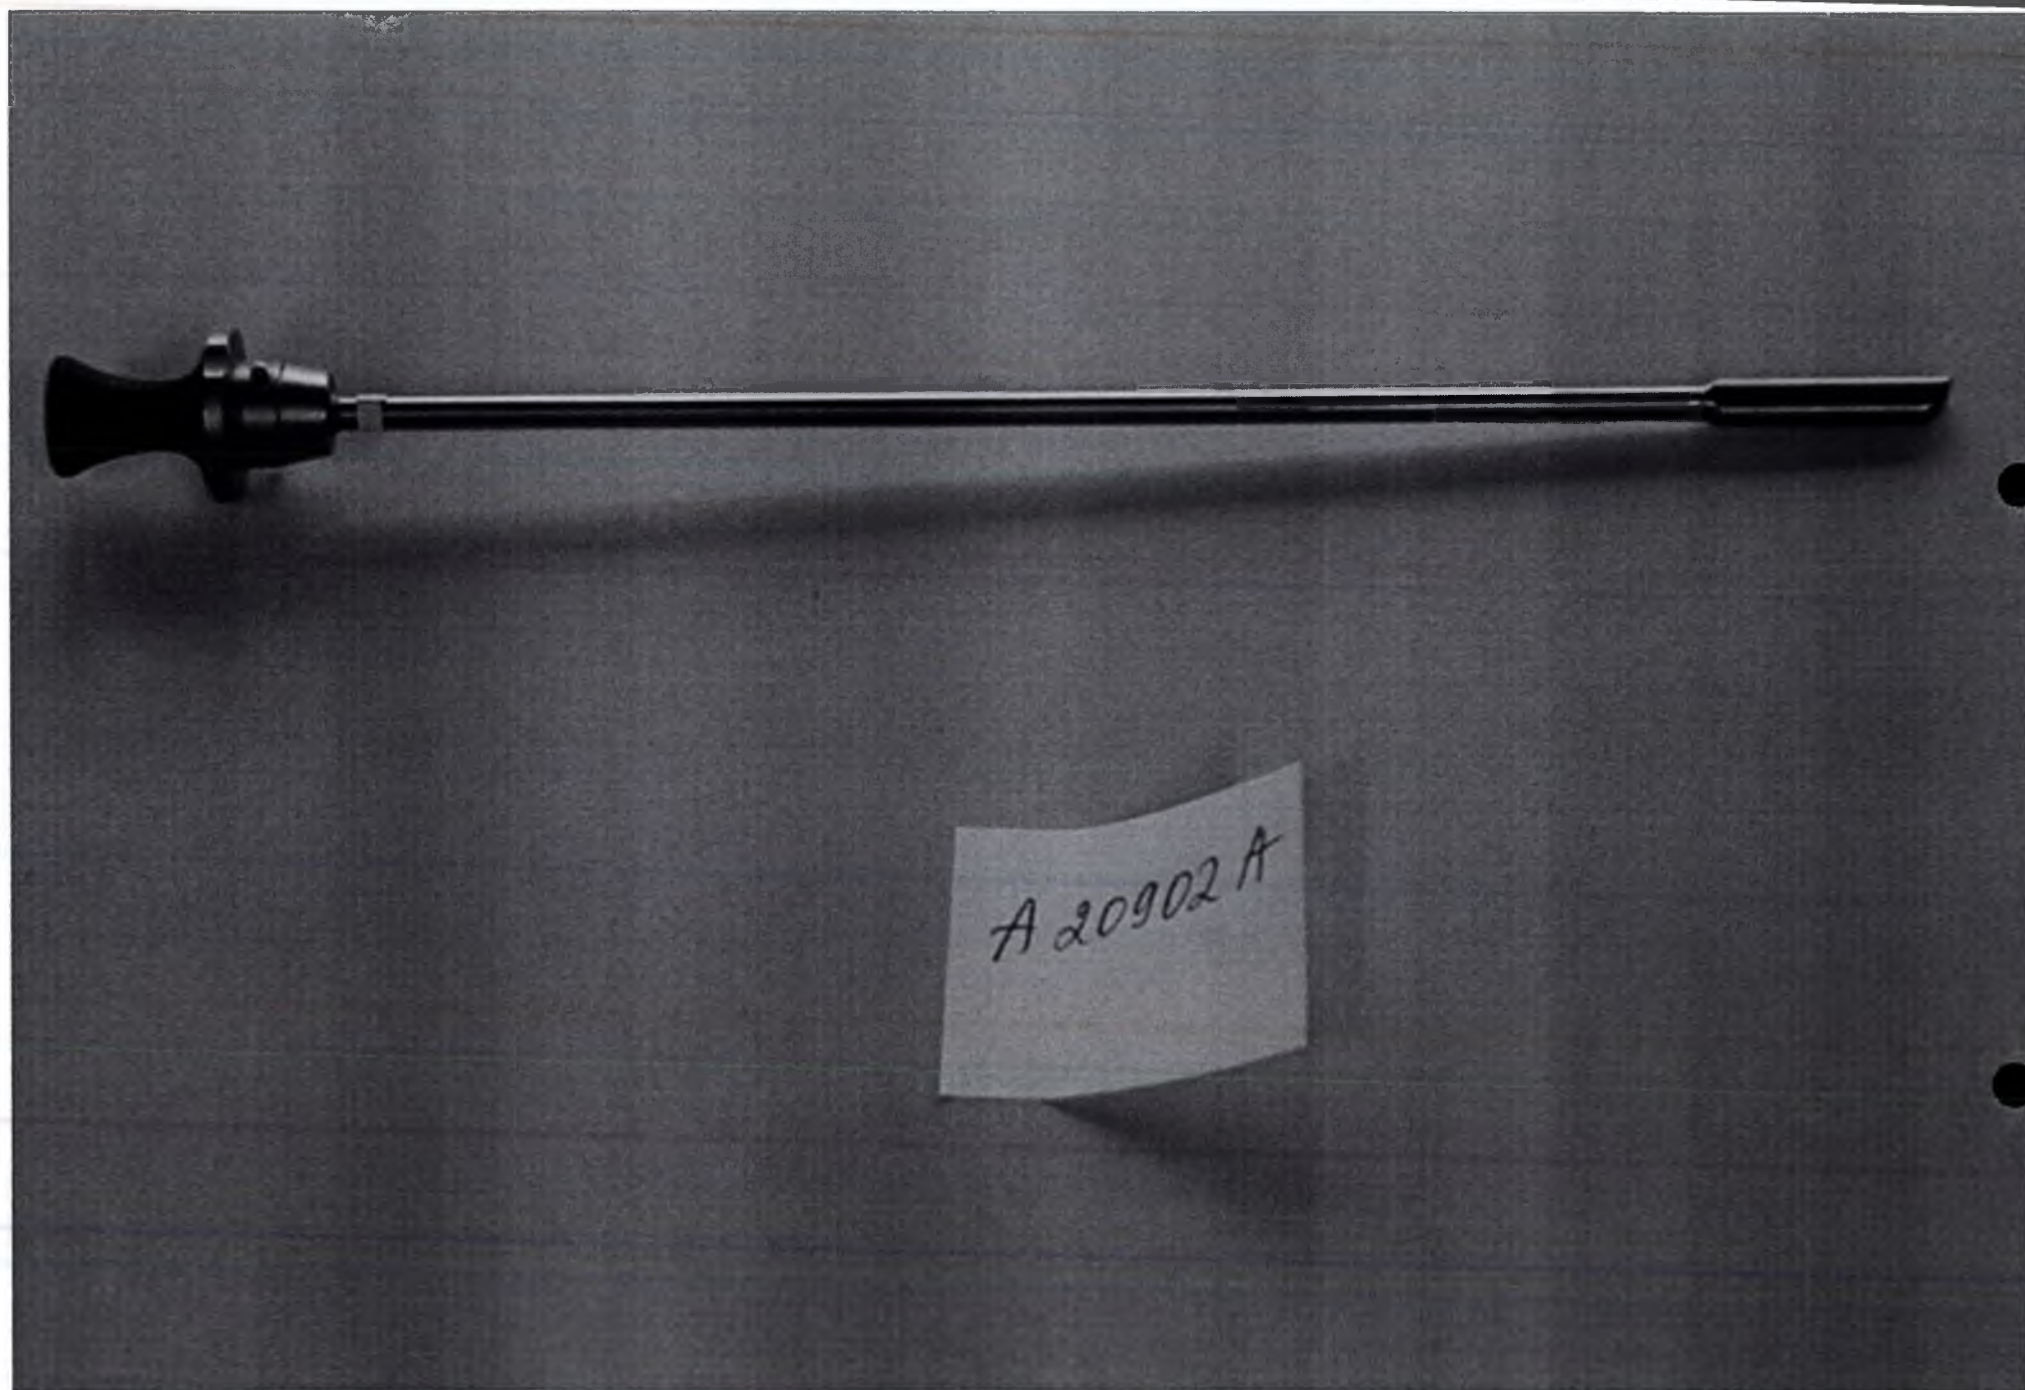

Обтюратор: WA22016A, WA22830A, WA22840A, A4742, A2284, A3560, WA33025A, A2662, A2283, A20902A, A20903A, A20904A, A20905A, A20906A, A20907A, A20908A, A20909A, A20910A.

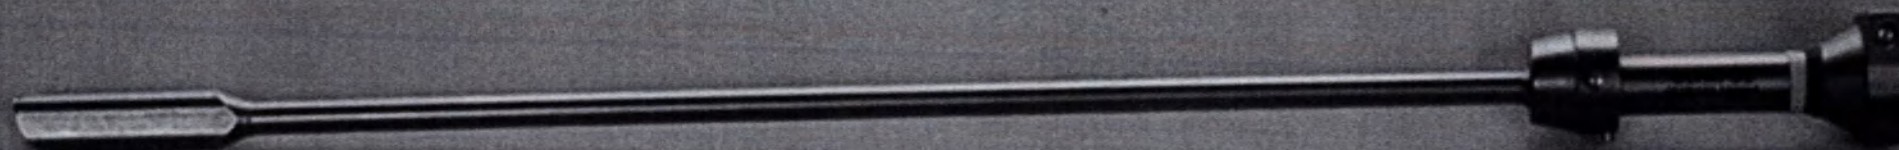

A 20925A

Обтюратор: A20922A, A20923A, A20924A, A20925A.



A 22071A

Обтюратор: A22071A, A22072A, A22073A.



A 22082 A

Обтюратор: A22081A, A22082A, A22083A, A22085A, A22086A, A22087A.



A42071A

Обтюратор: A42071A, A4766, A4767.

Обтюратор: WA22016A (макет маркировки)


Артикул	Обтюратор: WA22016A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Щипцы: A65325A, A63010A, A63010L, A63010S, A63013A, A63013L, A63013S, A63015A, A63020A, A63023A, A63025A, A63030A, A63033A, A63035A, A63040A, A63043A, A63045A, A63050A, A63053A, A63055A, A63060A, A63063A, A63065A, A63070A, A63073A, A63075A, A63080A, A63083A, A63085A, A63090A, A63093A, A63095A, A63100A, A63103A, A63105A, A63110A, A63113A, A63115A, A63120A, A63120S, A63123A, A63123S, A63125A, A63310A, A63310S, A63313A, A63313S, A63315A, A63320A, A63320L, A63320S, A63323A, A63323L, A63323S, A63325A, A63340A, A63343A, A63345A, A63610A, A63610L, A63610S, A63613A, A63613L, A63613S, A63615A, A63620A, A63623A, A63625A, A63810A, A63810L, A63810S, A63813A, A63813L, A63813S, A63815A, A63820A, A63820L, A63820S, A63823A, A63823L, A63823S, A63825A, A63830A, A63833A, A63835A, A63840A, A63843A, A63845A, A65020A, A65023A, A65025A, A65050A, A65053A, A65055A, A65060A, A65063A, A65065A, A65070A, A65073A, A65075A, A65310A, A65313A, A65315A, A65320A, A65323A, WA63120L, WA63123L, WA63125L, WA63130A, WA63133A, WA63135A, WA63140A, WA63143A, WA63145A, WA63330A, WA63333A, WA63335A, WA65040A, WA65043A, WA65045A, A7862, A7860, A7872, A7871, A7873, A7870, A7881, A7882, A7880, A7883, A7790, A7791, A3661, WA69010L, WA69010M, WA69012L, WA69012M, WA69014L, WA69014M, WA69016L, WA69016M, WA69018L, WA69018M, WA69020L, WA69020M, WA69022L, WA69022M, WA69024L, WA69024M, WA69030L, WA69030M, WA69032L, WA69032M, WA69034L, WA69034M, WA69036L, WA69036M, WA69038L, WA69038M, WA69040L, WA69040M, WA69042L, WA69042M, WA69044L, WA69044M, WA69046L, WA69046M, WA69050L, WA69050M, WA69052L, WA69052M, WA69054L, WA69054M, WA69056L, WA69056M, WA69058L, WA69058M, WA69084L, WA69084M, WA69090L, WA69090M, WA69092L, WA69092M, WA69210L, WA69210M, WA69212L, WA69212M, WA69214L, WA69214M, WA69216L, WA69216M, WA69218L, WA69218M, WA69220L, WA69220M, WA69222L, WA69222M, WB990202, WB990033, WB990034.

Щипцы: А65325А (макет маркировки)


Артикул	Щипцы: А65325А
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

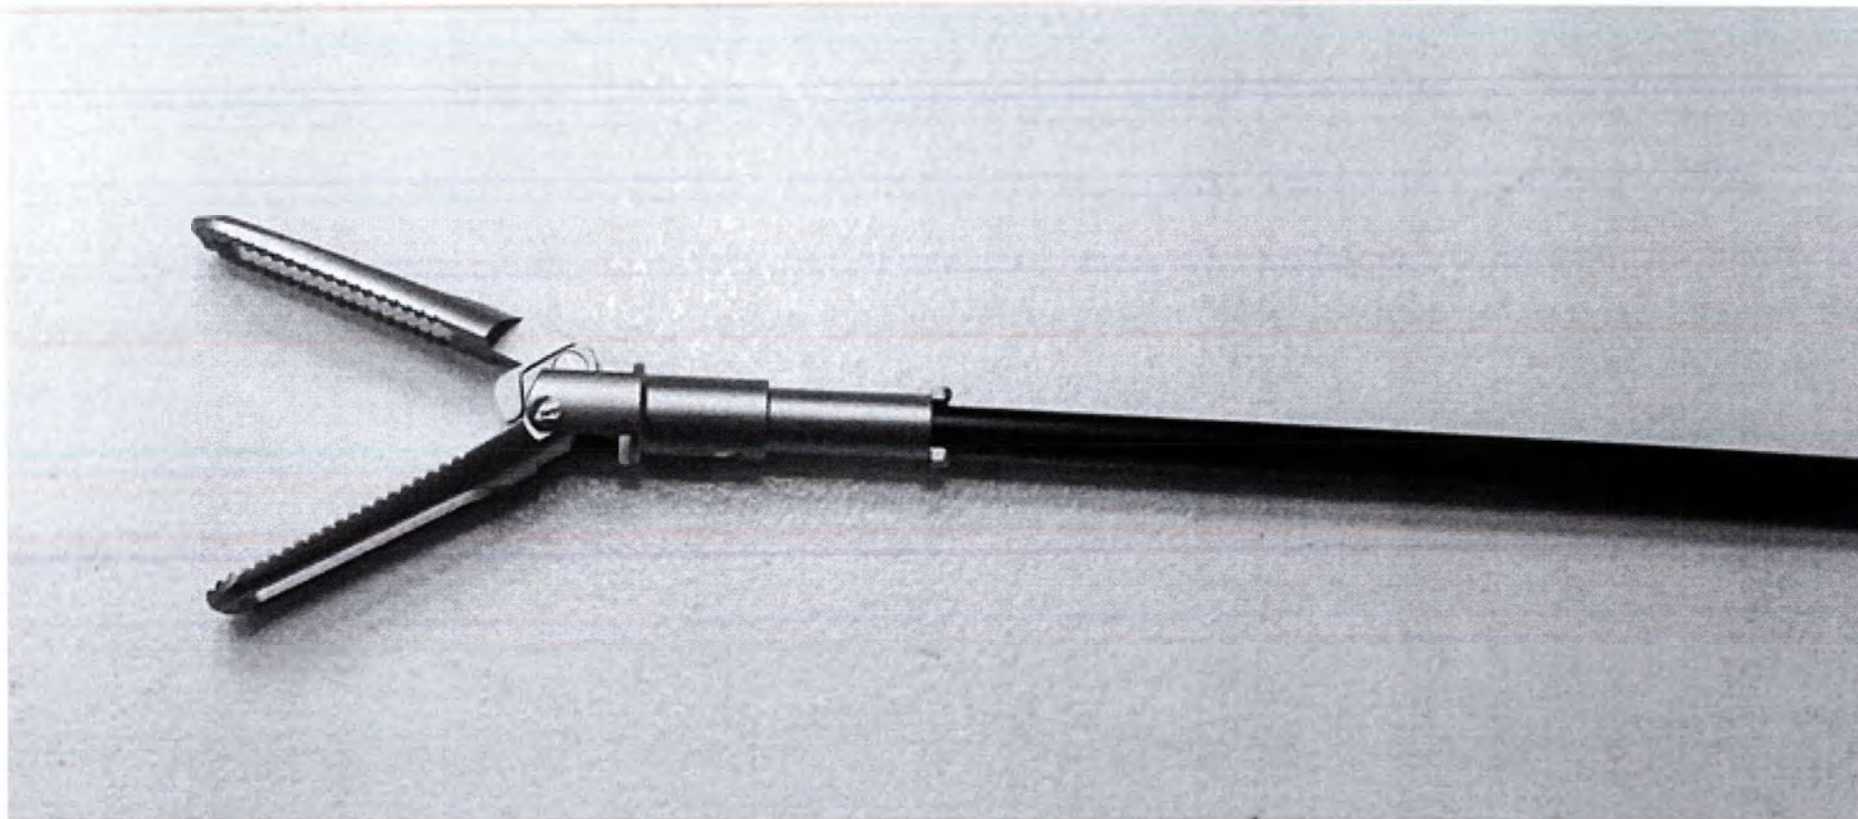

- Рабочая часть: WA69310L, WA69310M, WA69310S, WA69312L, WA69312M, WA69312S, WA69314L, WA69314M, WA69314S, WA69316L, WA69316M, WA69316S, WA69318L, WA69318M, WA69318S, WA69320L, WA69320M, WA69320S, WA69322M, WA69324M, WA69326S, WA69328S, WA69330L, WA69330M, WA69330S, WA69332L, WA69332M, WA69332S, WA69334L, WA69334M, WA69334S, WA69336L, WA69336M, WA69336S, WA69338L, WA69338M, WA69338S, WA69340L, WA69340M, WA69340S, WA69342L, WA69342M, WA69342S, WA69344L, WA69344M, WA69344S, WA69346L, WA69346M, WA69346S, WA69350L, WA69350M, WA69350S, WA69352L, WA69352M, WA69352S, WA69354M, WA69356L, WA69356M, WA69356S, WA69358L, WA69358M, WA69358S, WA69370L, WA69370M, WA69370S, WA69372L, WA69372M, WA69372S, WA69374L, WA69374M, WA69374S, WA69376L, WA69376M, WA69376S, WA69380M, WA69382M, WA69384L, WA69384M, WA69384S, WA69390L, WA69390M, WA69392L, WA69392M, WA69410M, WA69412M, WA69414M, WA69416M, WA69418M, WA69420M, WA69422M.

Рабочая часть: WA69310L (макет маркировки)

Артикул	Рабочая часть: WA69310L
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

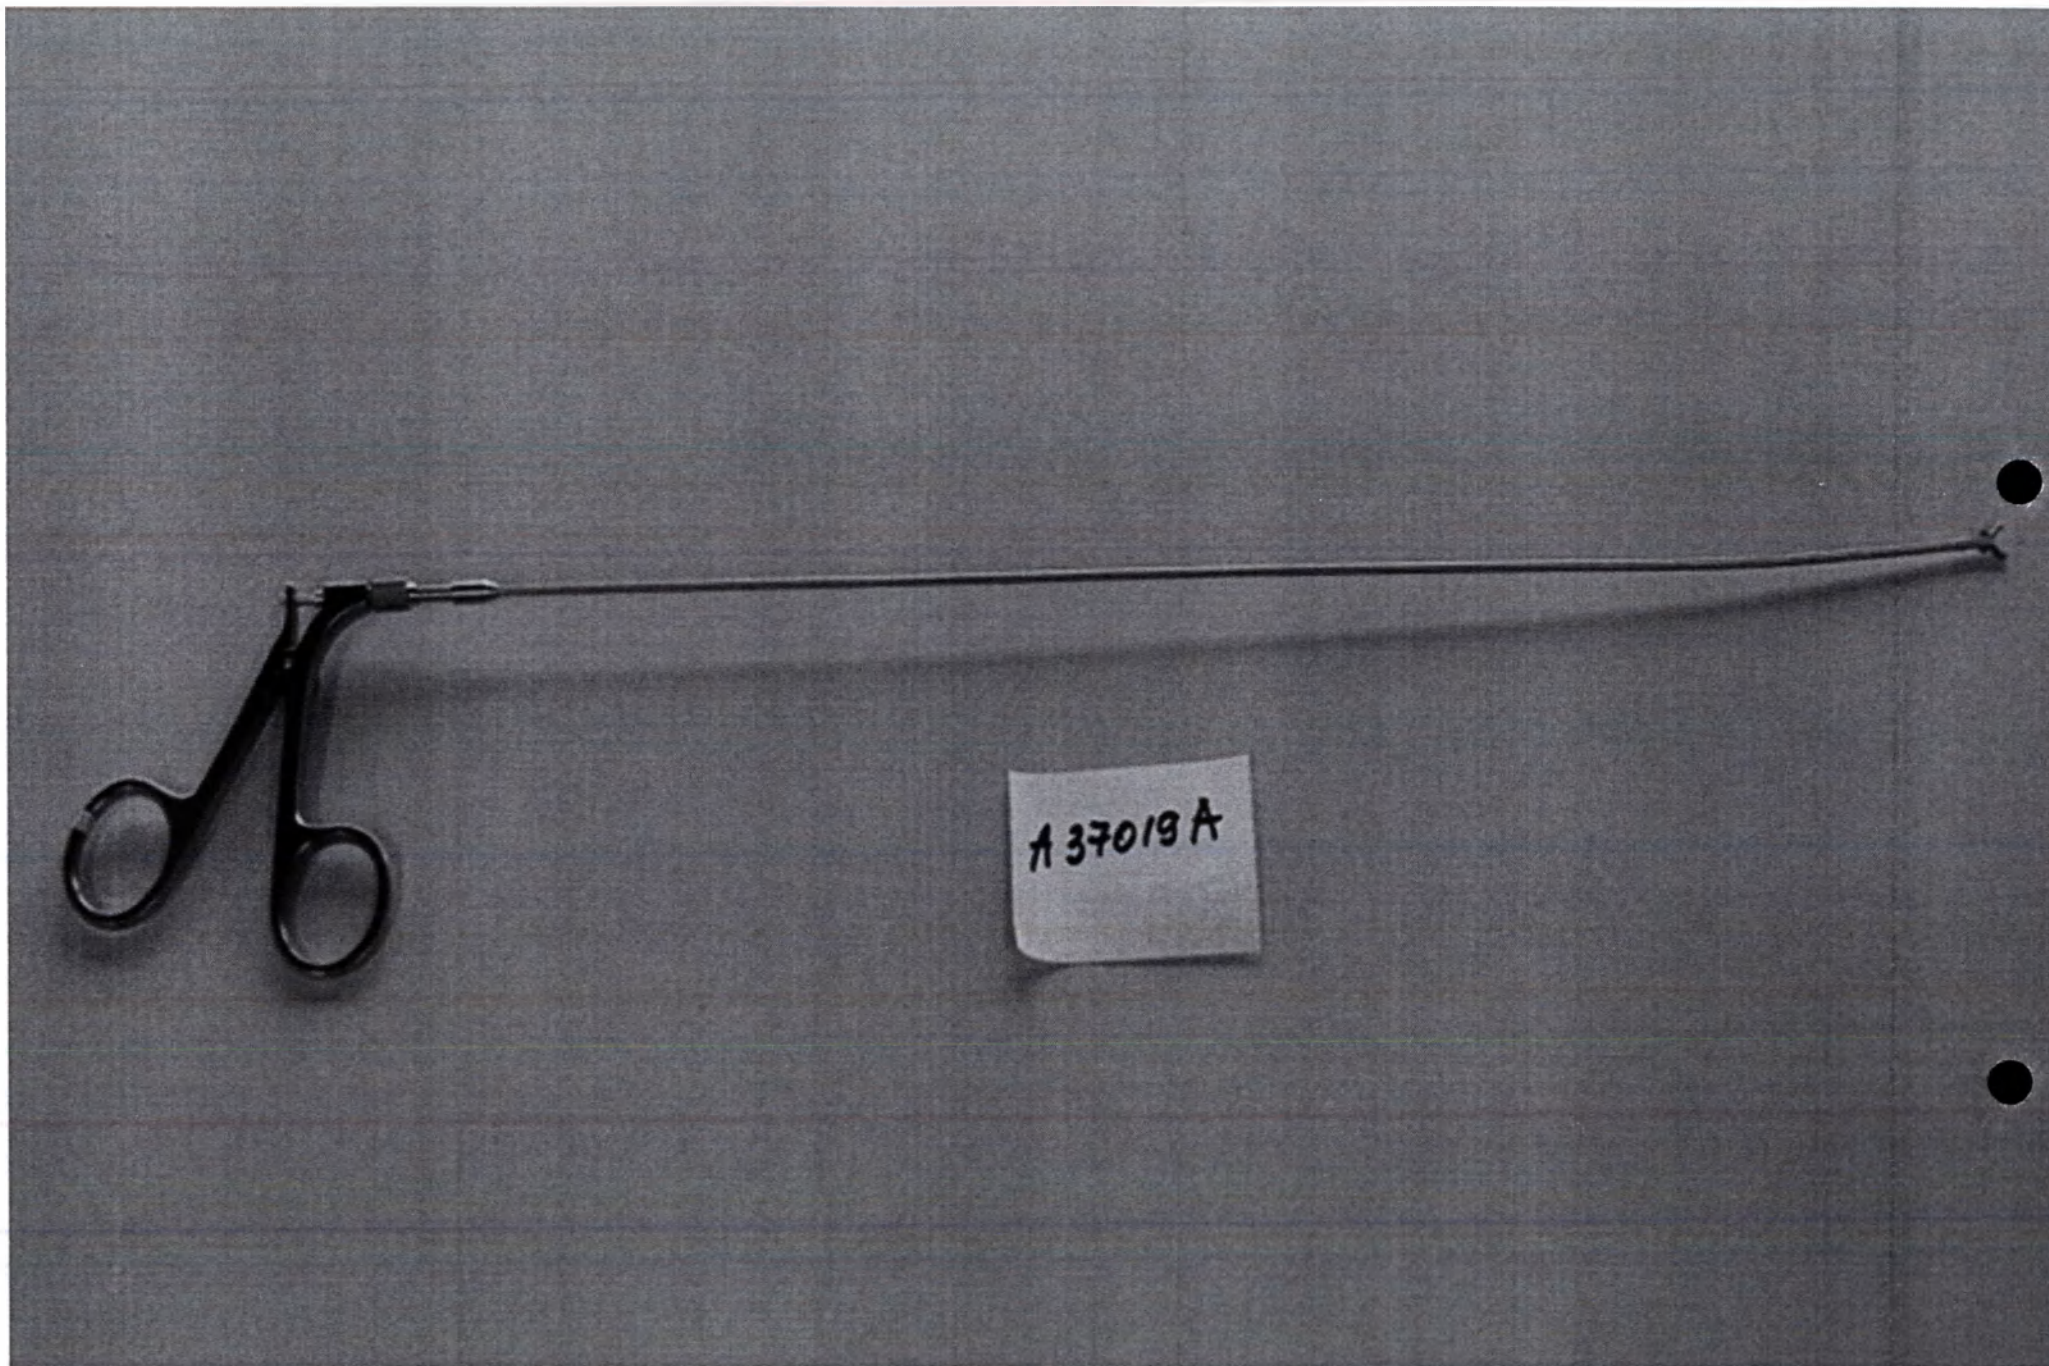

Щипцы биопсийные: A4616, A4679, O0123, O0124, A2423, A2499, A7793, A3651, A20712A, A20713A, A20715A, A20716A, A20719A, A2577, A37016A,

Щипцы биопсийные: А4616 (макет маркировки)


Артикул	Щипцы биопсийные: А4616
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Щипцы биполярные: A5382, A5386, A5390, A5394, WA64120C, WA64200C, WA64050C, WA64210C, WA64320C, WA64310C, WA64121C, WA64201C, WA64051C, WA64211C, WA64321C, WA64311C, WA63320C, WA63310C, WA63321C, WA63311C.

Щипцы биполярные: А5382 (макет маркировки)


Артикул	Щипцы биполярные: А5382
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

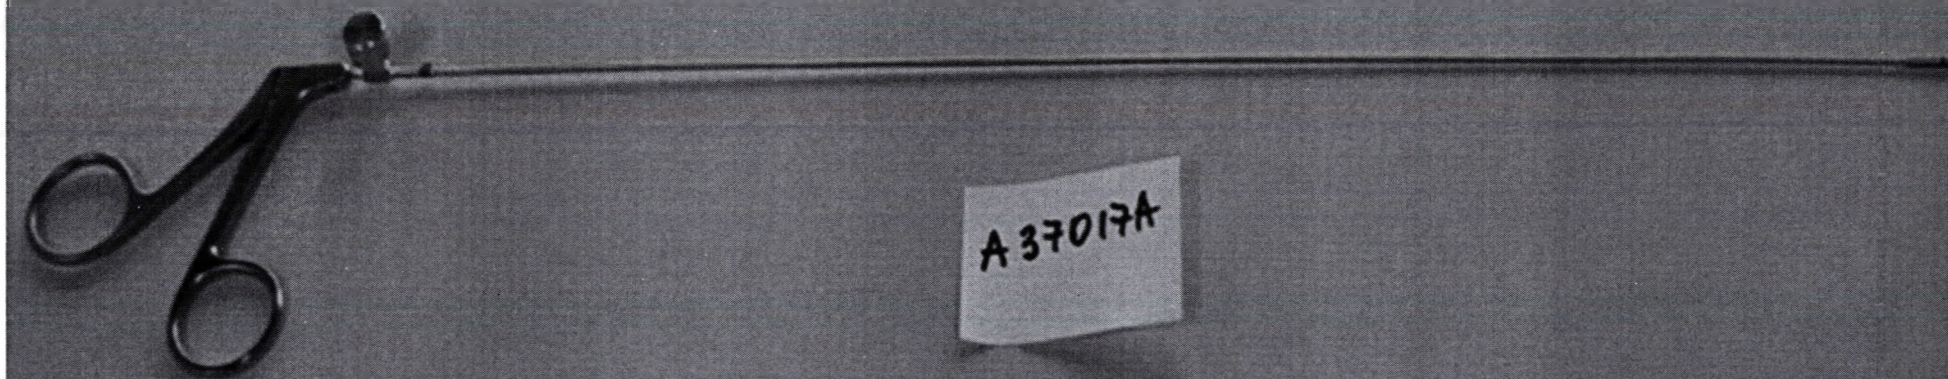

Щипцы захватывающие: A4618, A5651, A5698, O0121, O0122, O0125, WA56090L, WA56098L, WA63708A, WA63718A, WA63728A, WA63050C, WA63051C, A2427, WA63120C, WA63200C, WA63210C, WA63121C, WA63201C, WA63211C, A2580, A2592, A2500, A2422, WA63819A, WA63817A, WA63815A, A2421, WA63810A, WA63813A, A20710A, A20714A, A20718A, A2574, A2575, A37006A, A37015A, A37017A, A37018A, A4825, A4827, A4829, A4831.

Щипцы захватывающие: А4618 (макет маркировки)

Артикул	Щипцы захватывающие: А4618
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

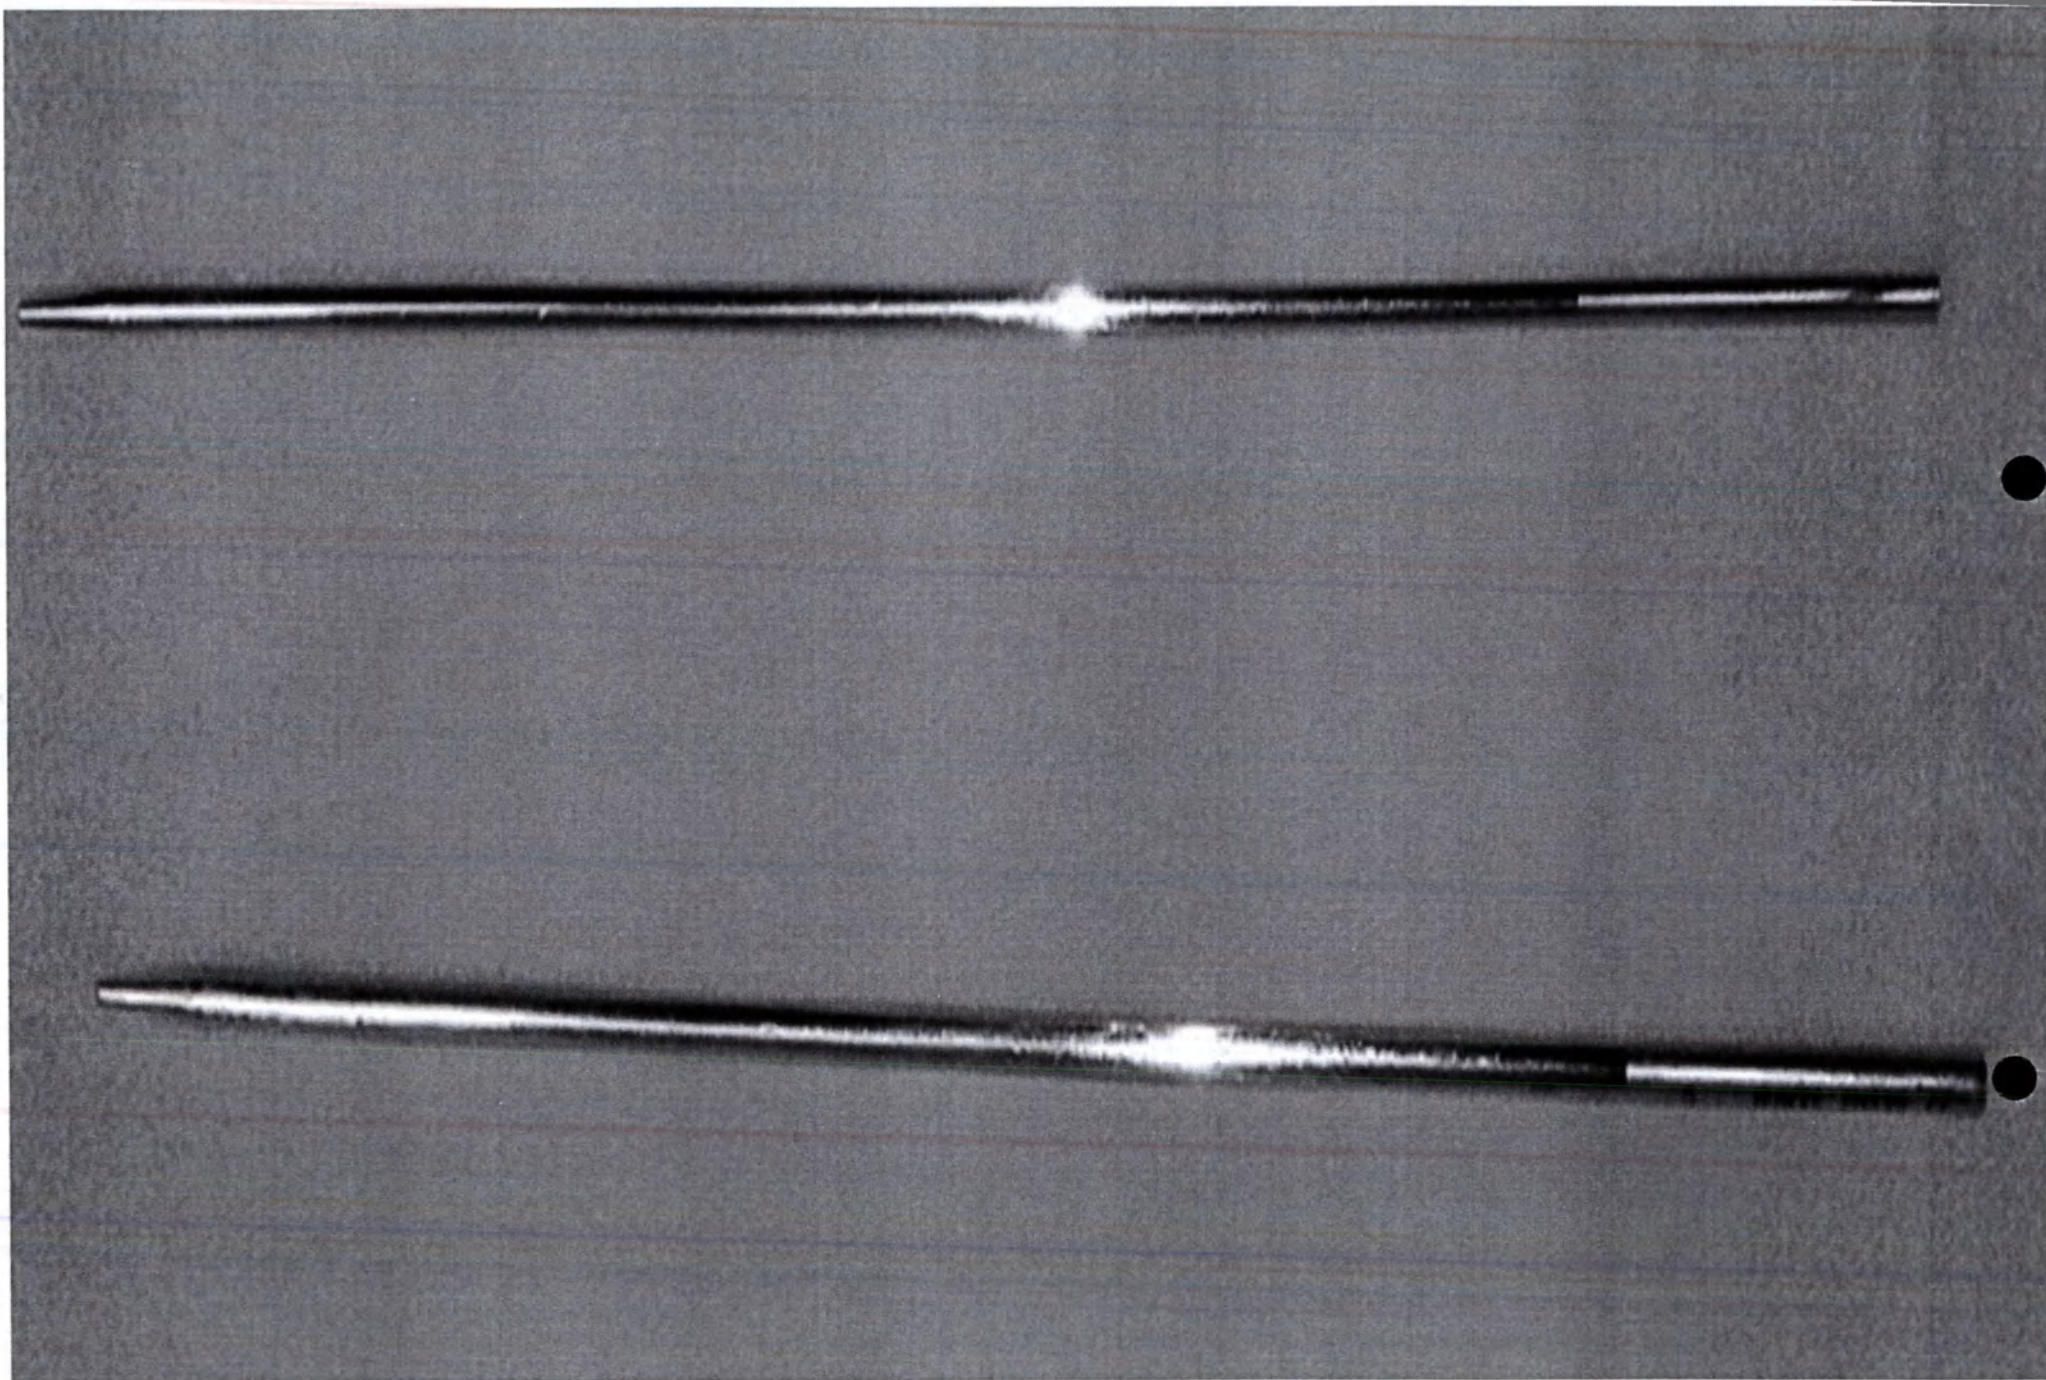

Бужи: WA33027A.

Бужи: WA33027A (макет маркировки)

Артикул	Бужи: WA33027A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




Дилататор: А5551, А5818.

Дилтатор: A5551(макет маркировки)

Артикул	Дилтатор: A5551
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Канюля: А5482 (макет маркировки)


Артикул	Канюля: А5482
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

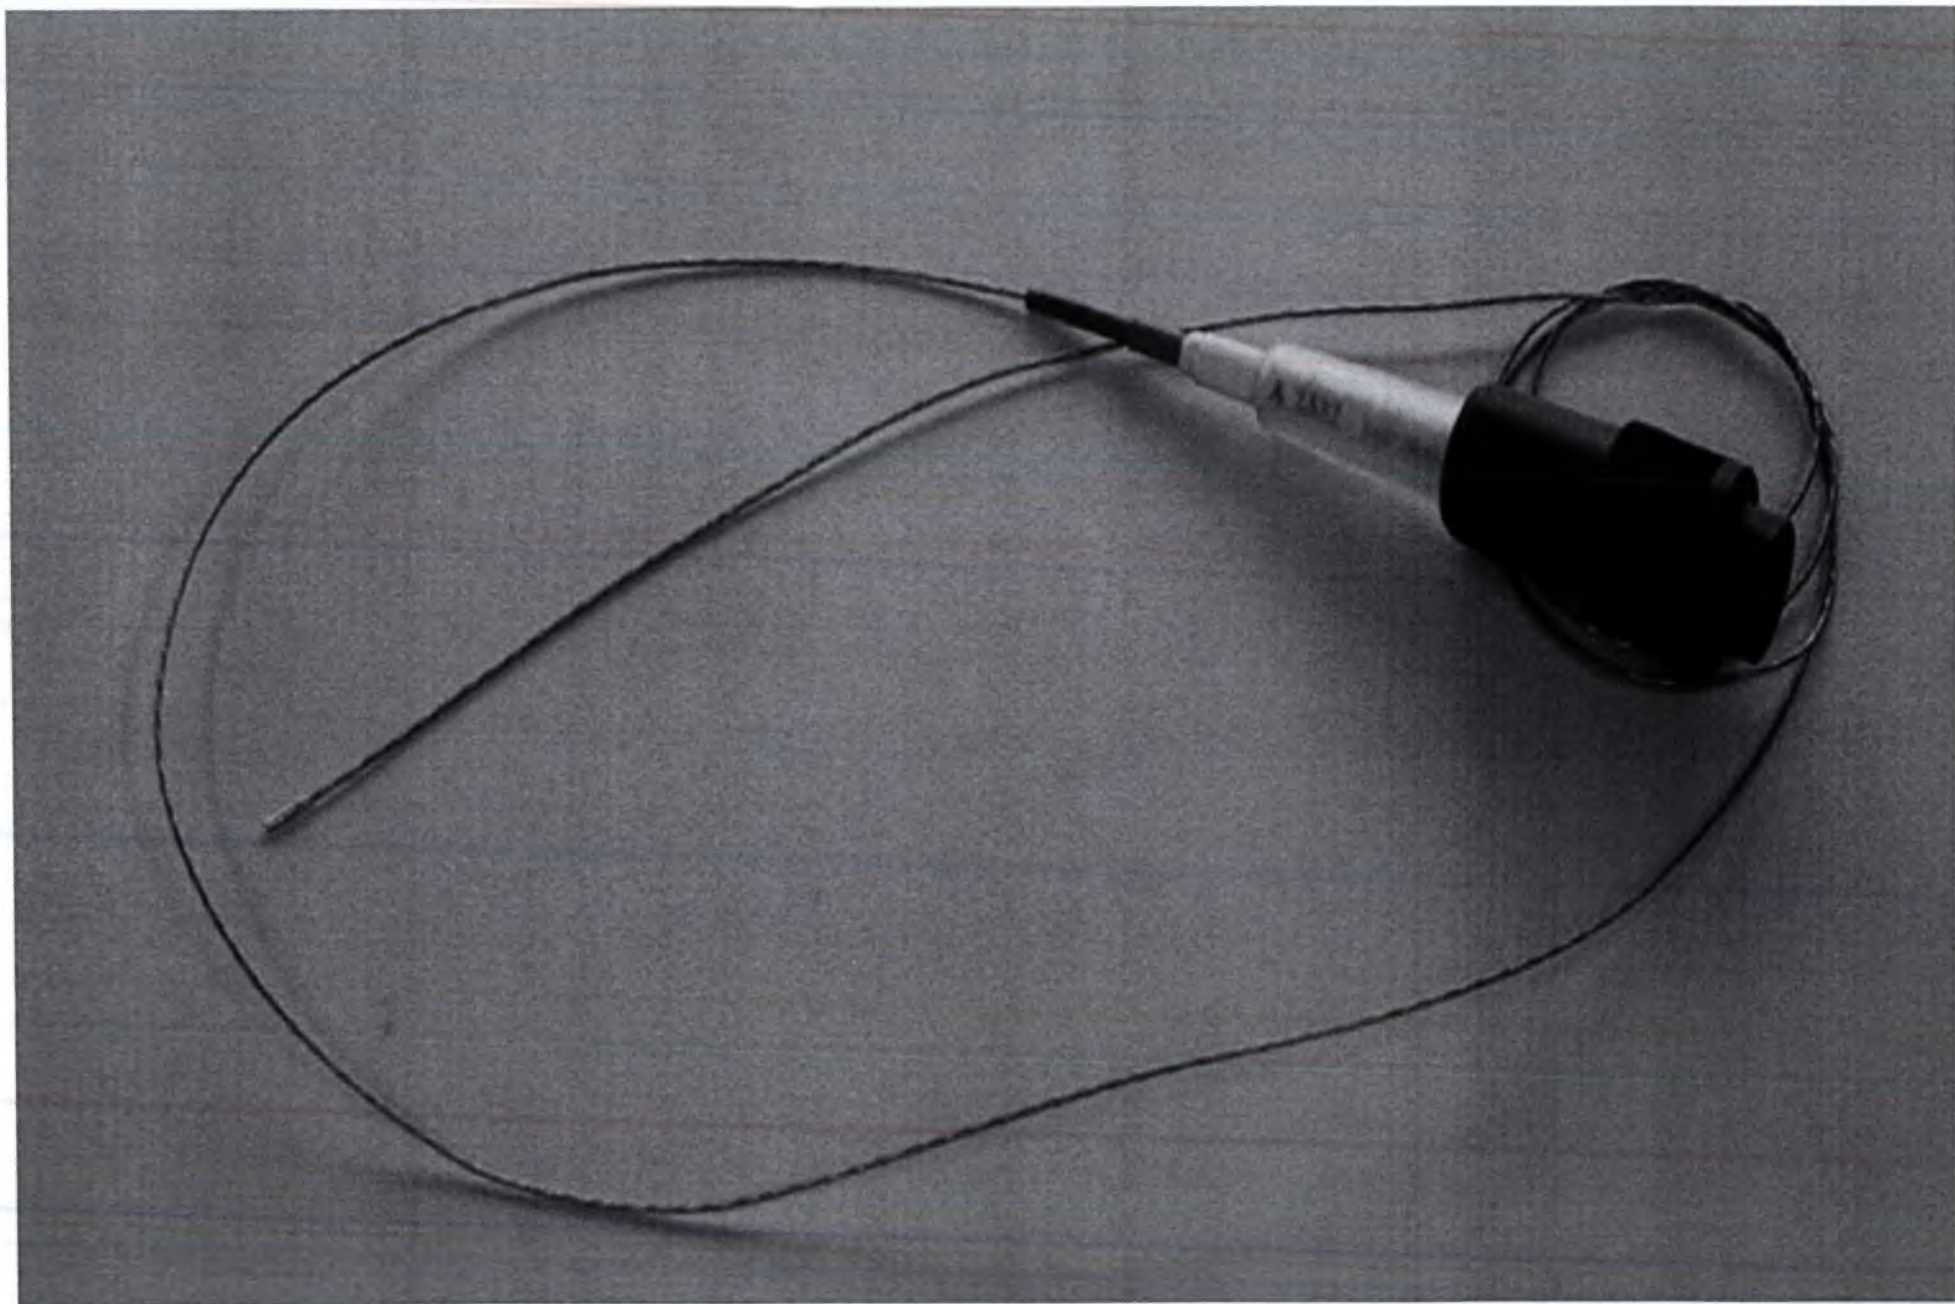


Зонд: WA25380A, A2538, WA25370A, WA25360A, A2536, A2535, A2539, WA02349A, WA02332A, WA02335A, A2335, WA02337A, A2331, WA09408A, A2325, WA09406A, A2537, A2349, A2332, A2336, A2337, A2304, A2302, A00561A, A00562A, SPL-PD097 (EGSPL-PDBX097, 3 шт.), SPL-PD150 (EGSPL-PDBX150, 3 шт.), SPL-PD183 (EGSPL-PDBX183, 3 шт.), SPL-PD340 (EGSPL-PDBX340, 3 шт.), SPL-PD376 (EGSPL-PDBX376, 3 шт.), SPL-PR097 (EGSPL-PR097), SPL-PR150 (EGSPL-PR150), SPL-PR183 (EGSPL-PR183), SPL-PR340 (EGSPL-PR340), SPL-PR376 (EGSPL-PR376).

Зонд: WA25380A (макет маркировки)


Артикул	Зонд: WA25380A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

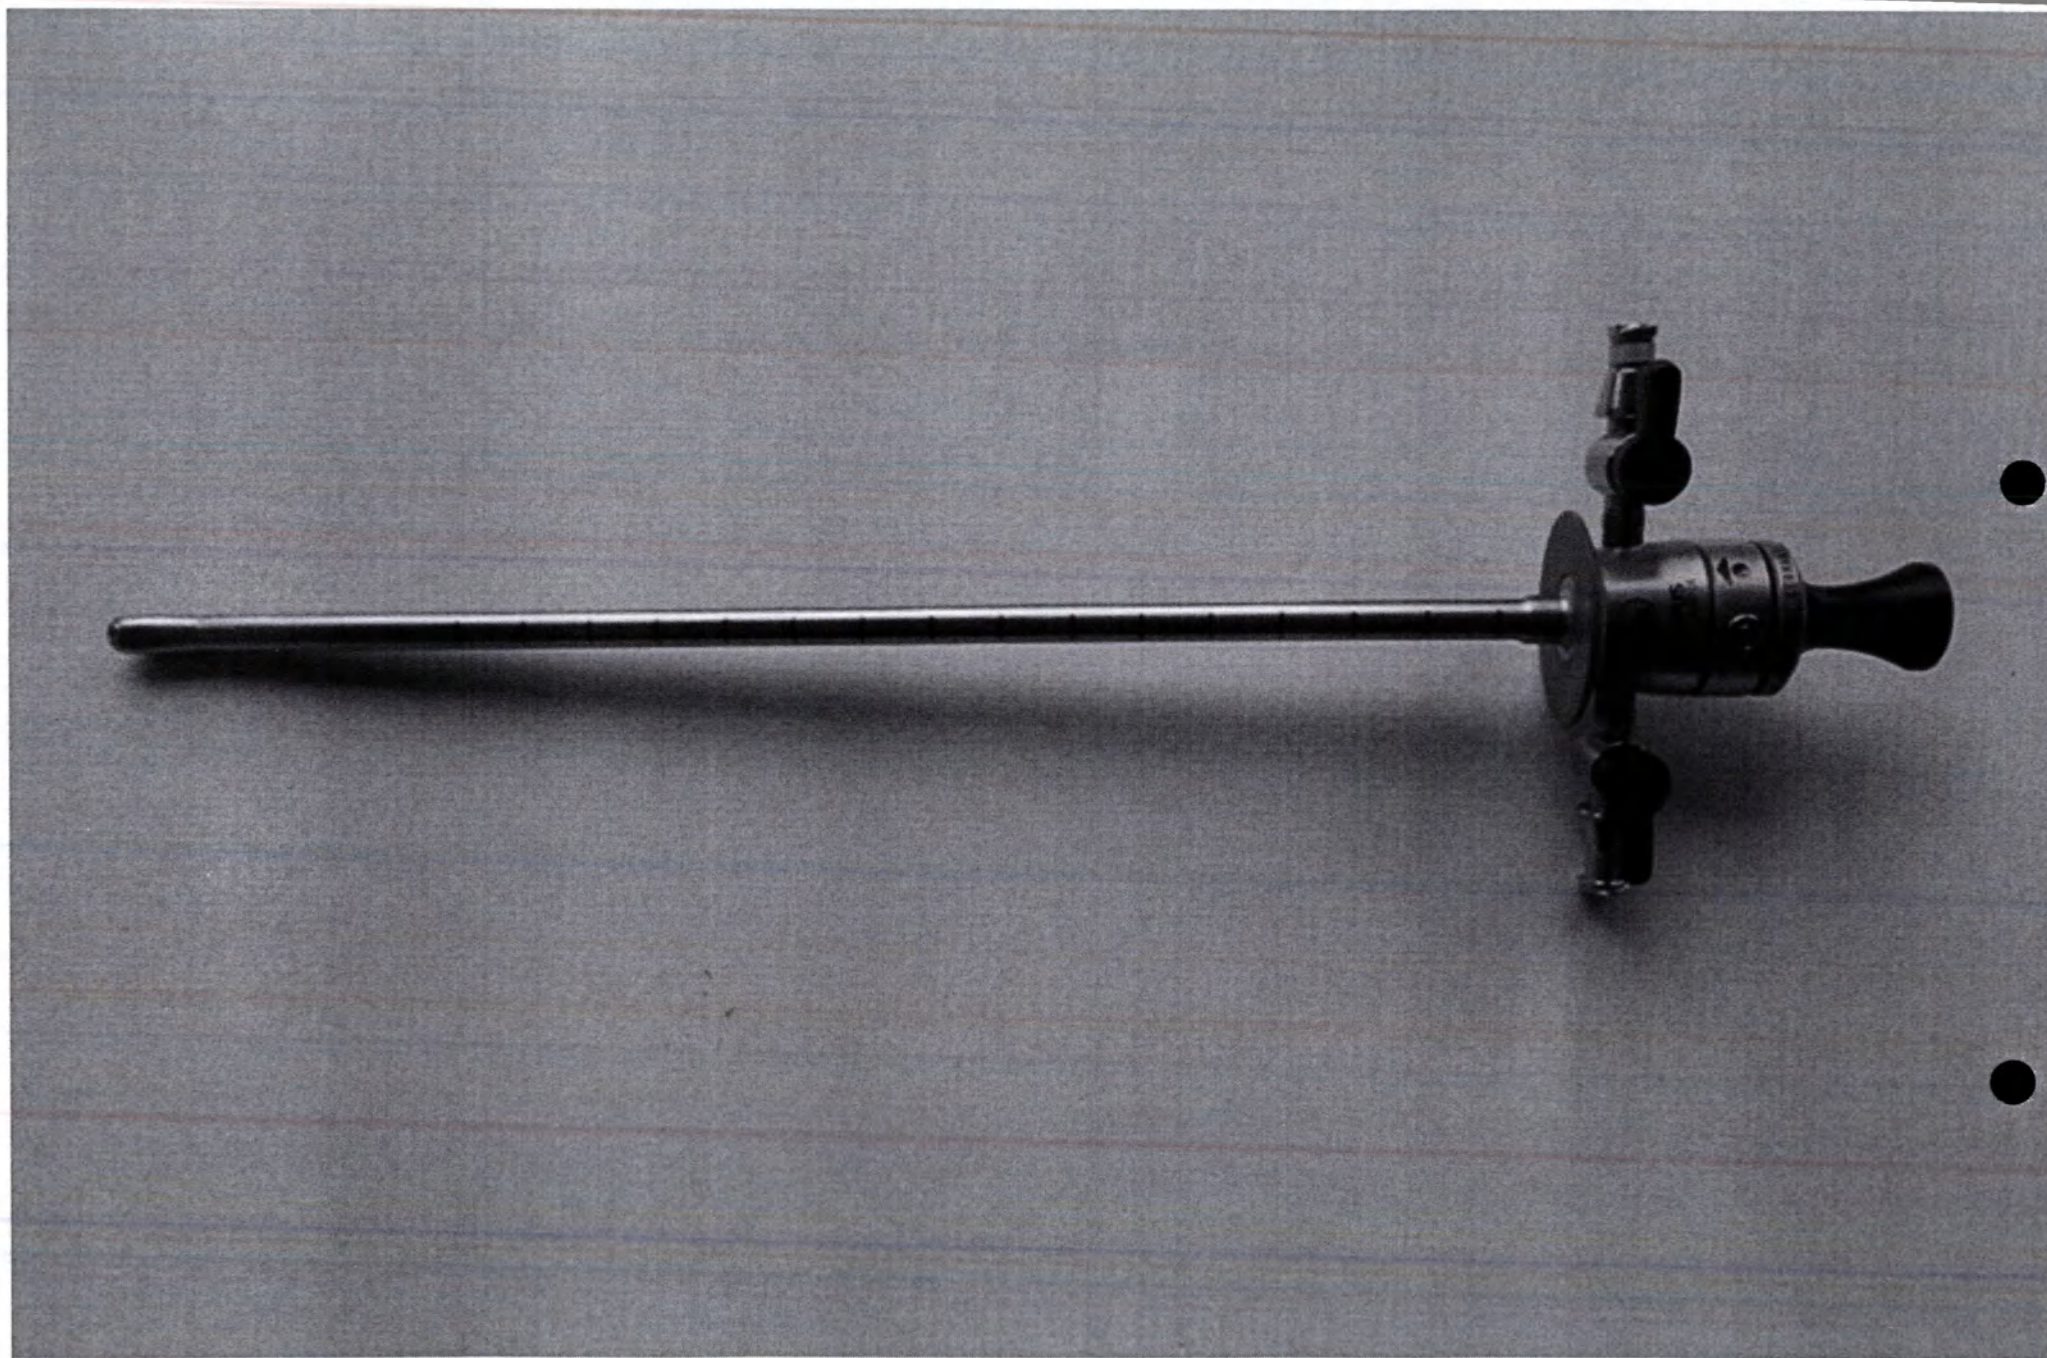

Тубус: A2282, A2660, WA22850A, A3554, A2247, A2661, A2281, WA33035A, A3552, WA33037A, A3551, WA33038A, A20911A, A20912A, A20913A, A20914A, A20915A, A20916A, A20930A, A20931A, A20933A, A20934A.

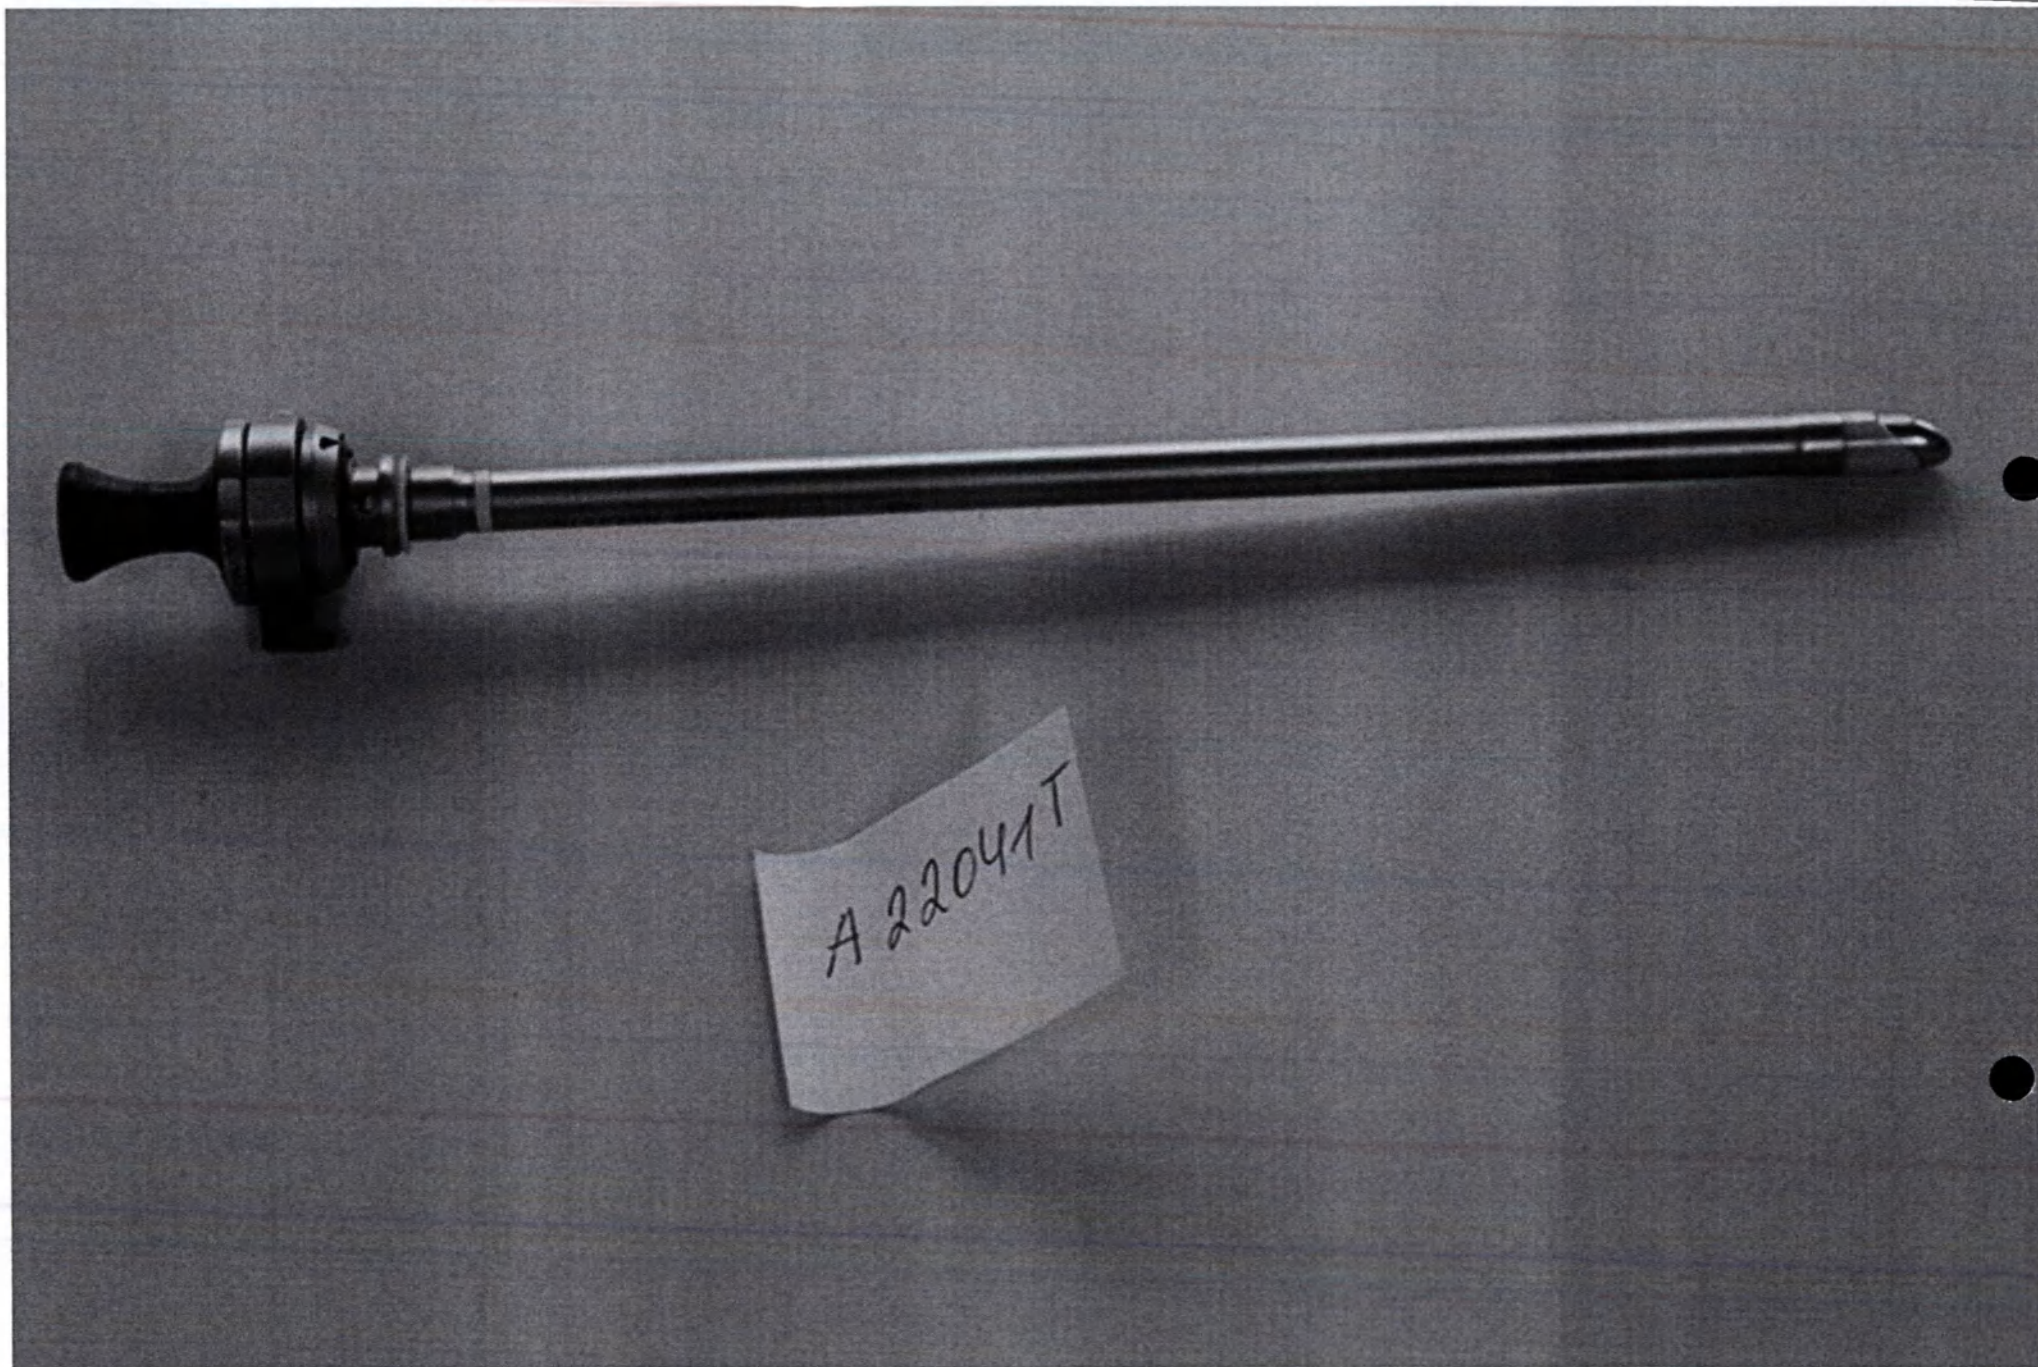

Тубус: A22041A, A22041T, A22042A, A22042T, A22043A, A22043T

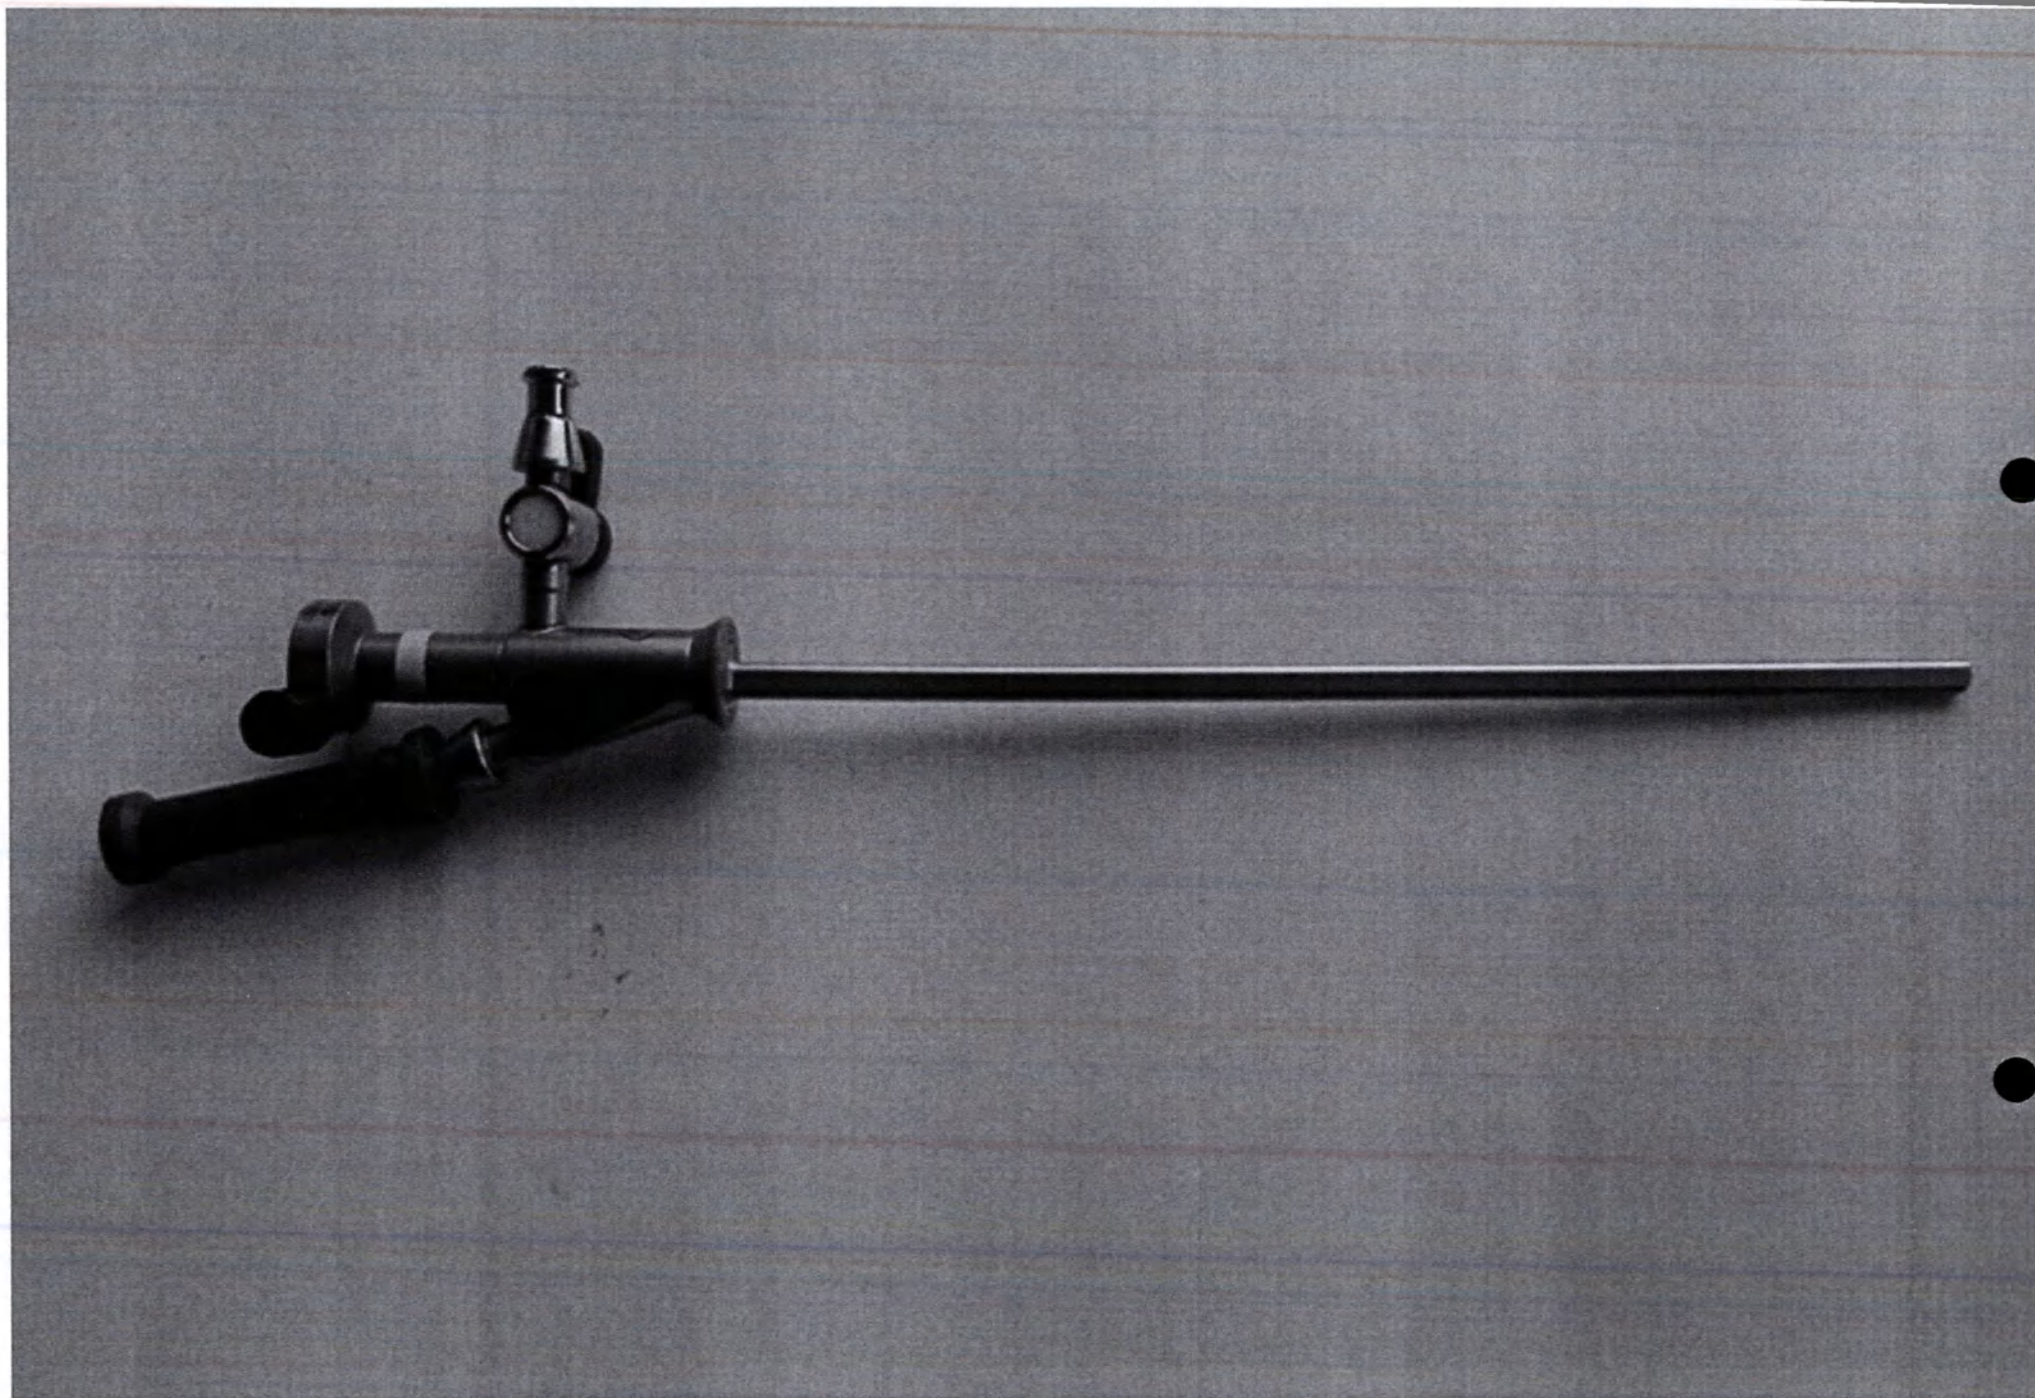

Тубыс: A37000A, A37001A, A37002A, A37003A, A37004A, A37028A.



A 4773

Тубыс: A4760, A4761, A47610A, A4763, A4770, A4771, A4772, A4773, A4775, A4776, , WA69300L, WA69300M, WA69300S, WA69400M.

Тубус: А2282 (макет маркировки)


Артикул	Тубус: А2282
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Тубус биполярный: А5397.

Тубус биполярный: A5397(макет маркировки)

Артикул	Тубус биполярный: A5397
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

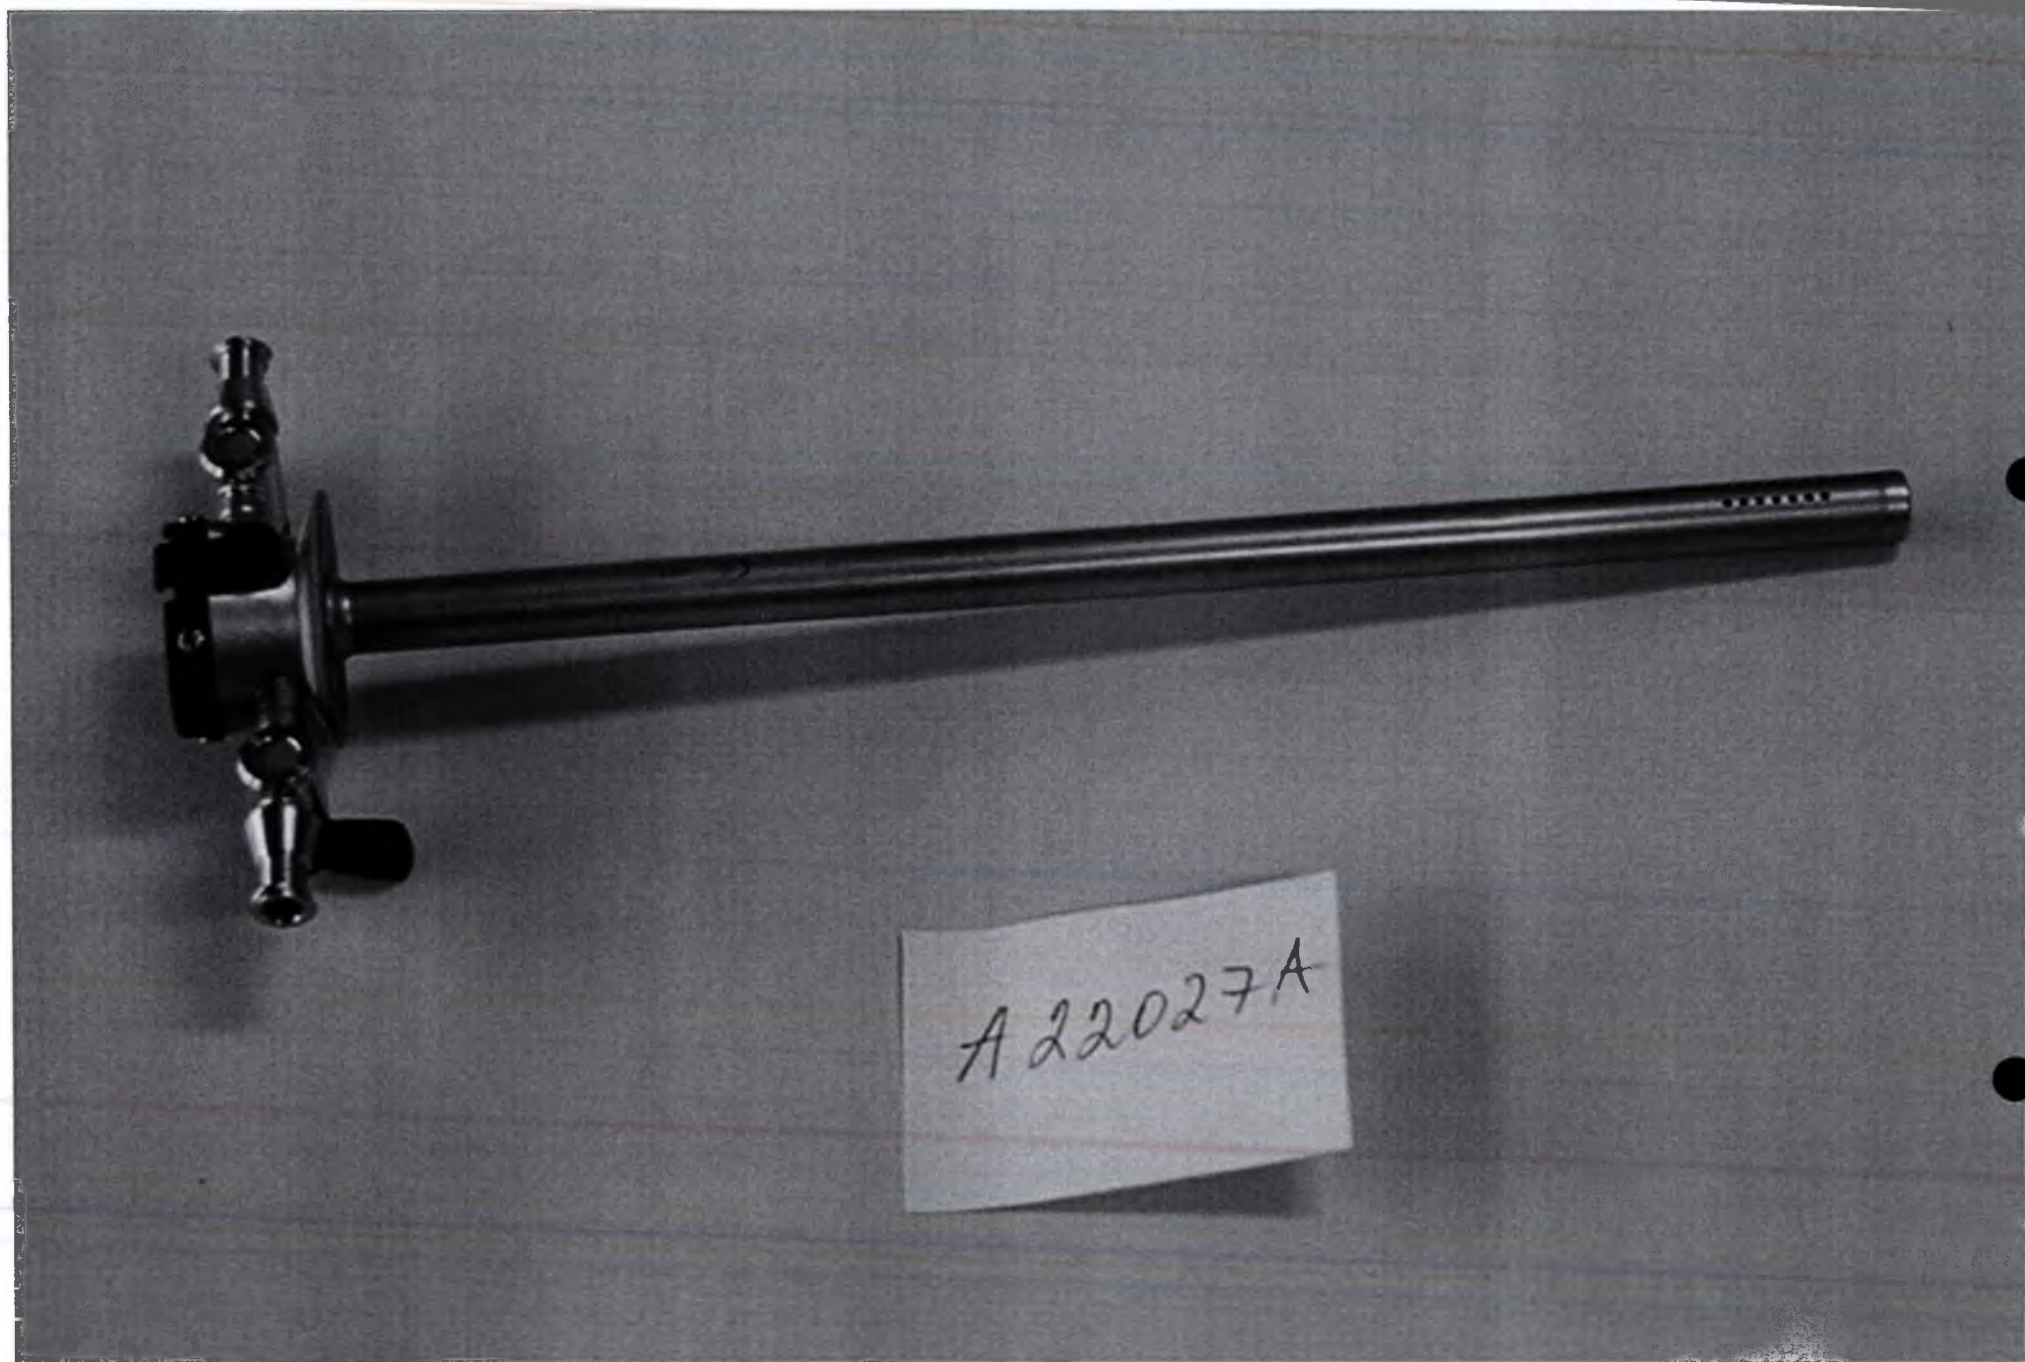

Тубус внешний: A4740, WA22018A, WA22019A, WA22810A, A22021A, A22022A, A22023A, A22024A, A22026A, A22027A, A37022A, A42021A.



A 22040A

Тубус внутренний: A4741, WA22017A, WA22017T, WA22820A, A22040A, A22040T, A42011A.

Тубус внешний: А4740 (макет маркировки)


Артикул	Тубус внешний: А4740
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Видеотелескоп: WA50002L, WA50010A, WA50012A, WA50012L, WA50014L, WA50020B, WA50022B, WA50080A, WA50082A.


Видеотелескоп: WA50002L (макет маркировки)

Артикул	Видеотелескоп: WA50002L
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнцтрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

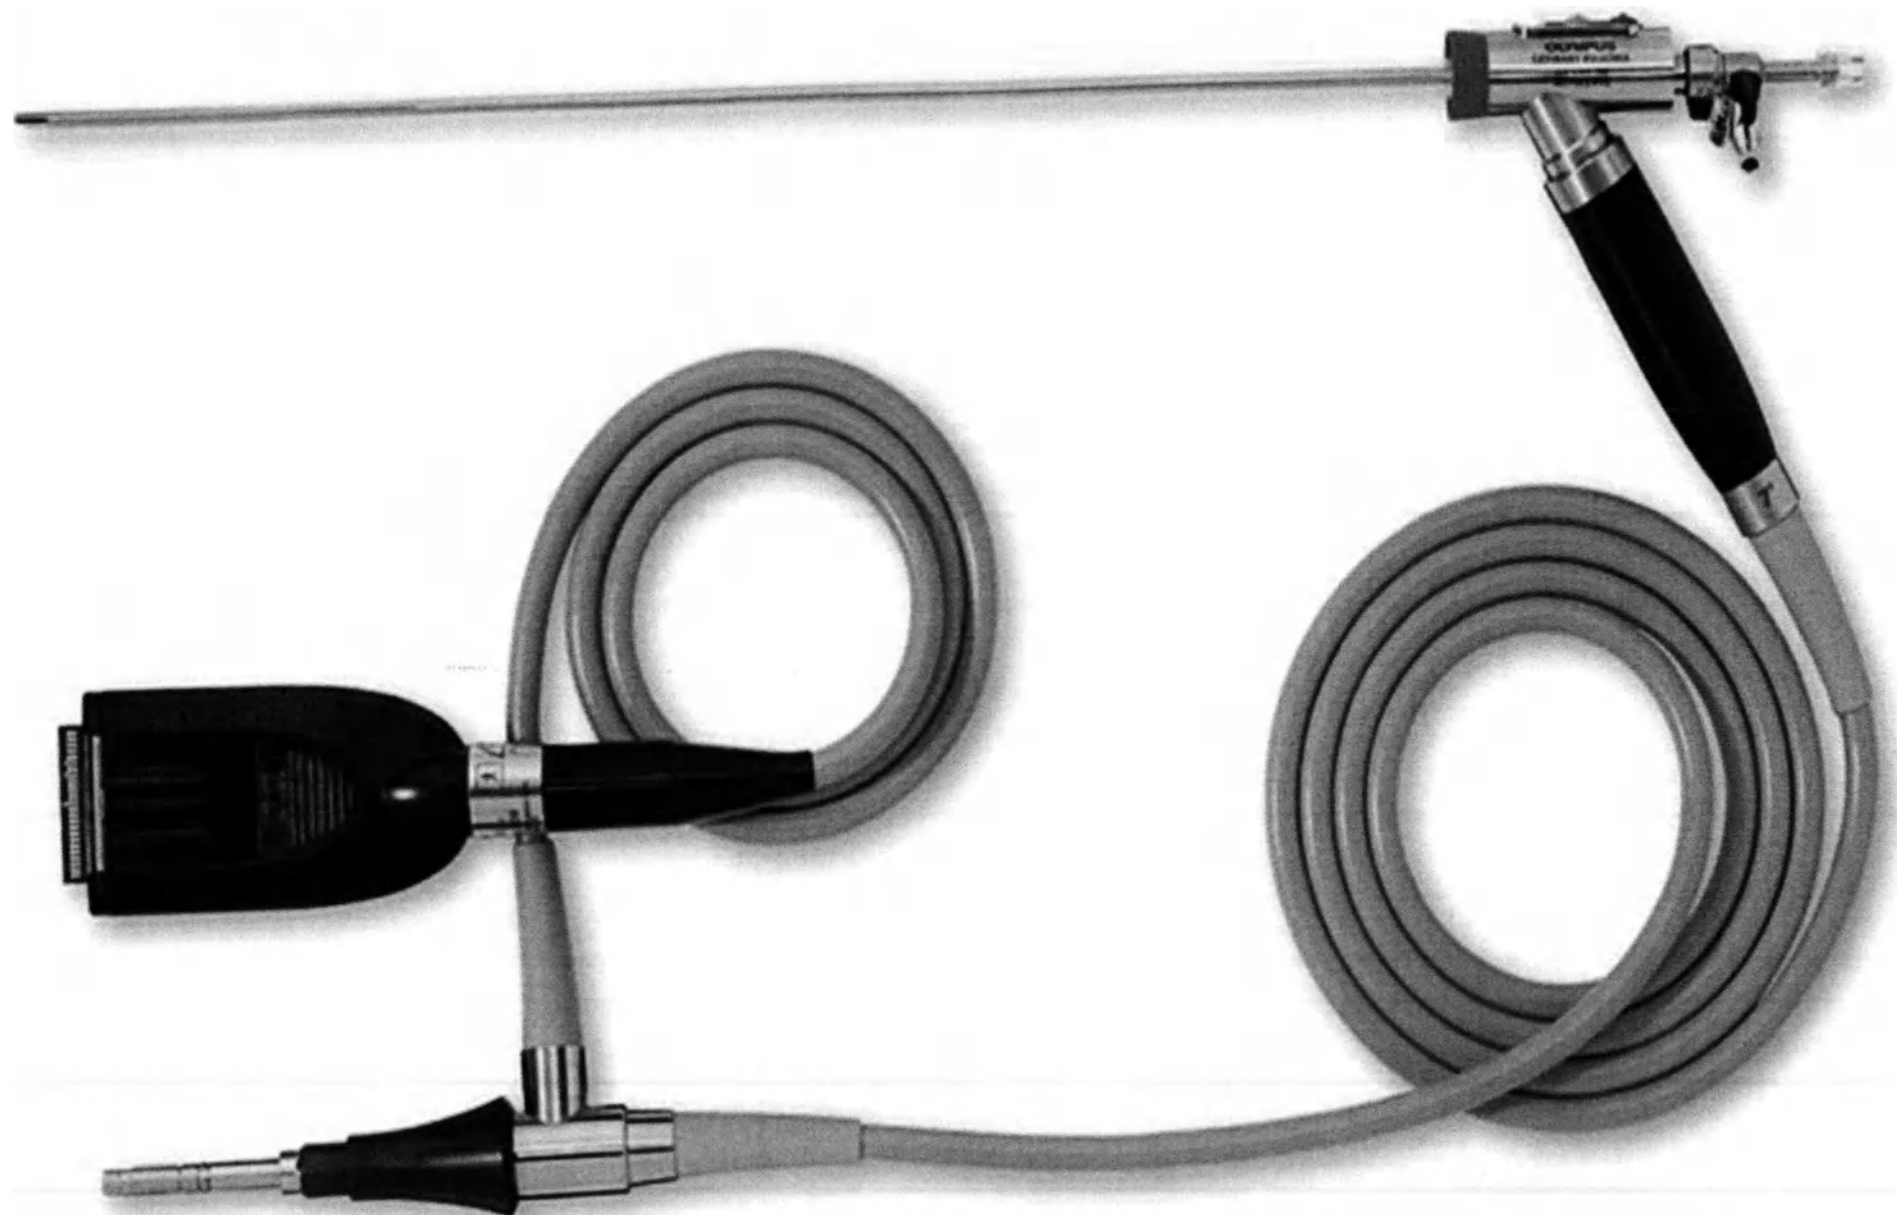

Уретероскоп WA50200A.(макет маркировки)


Артикул	Уретероскоп WA50200A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация. опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

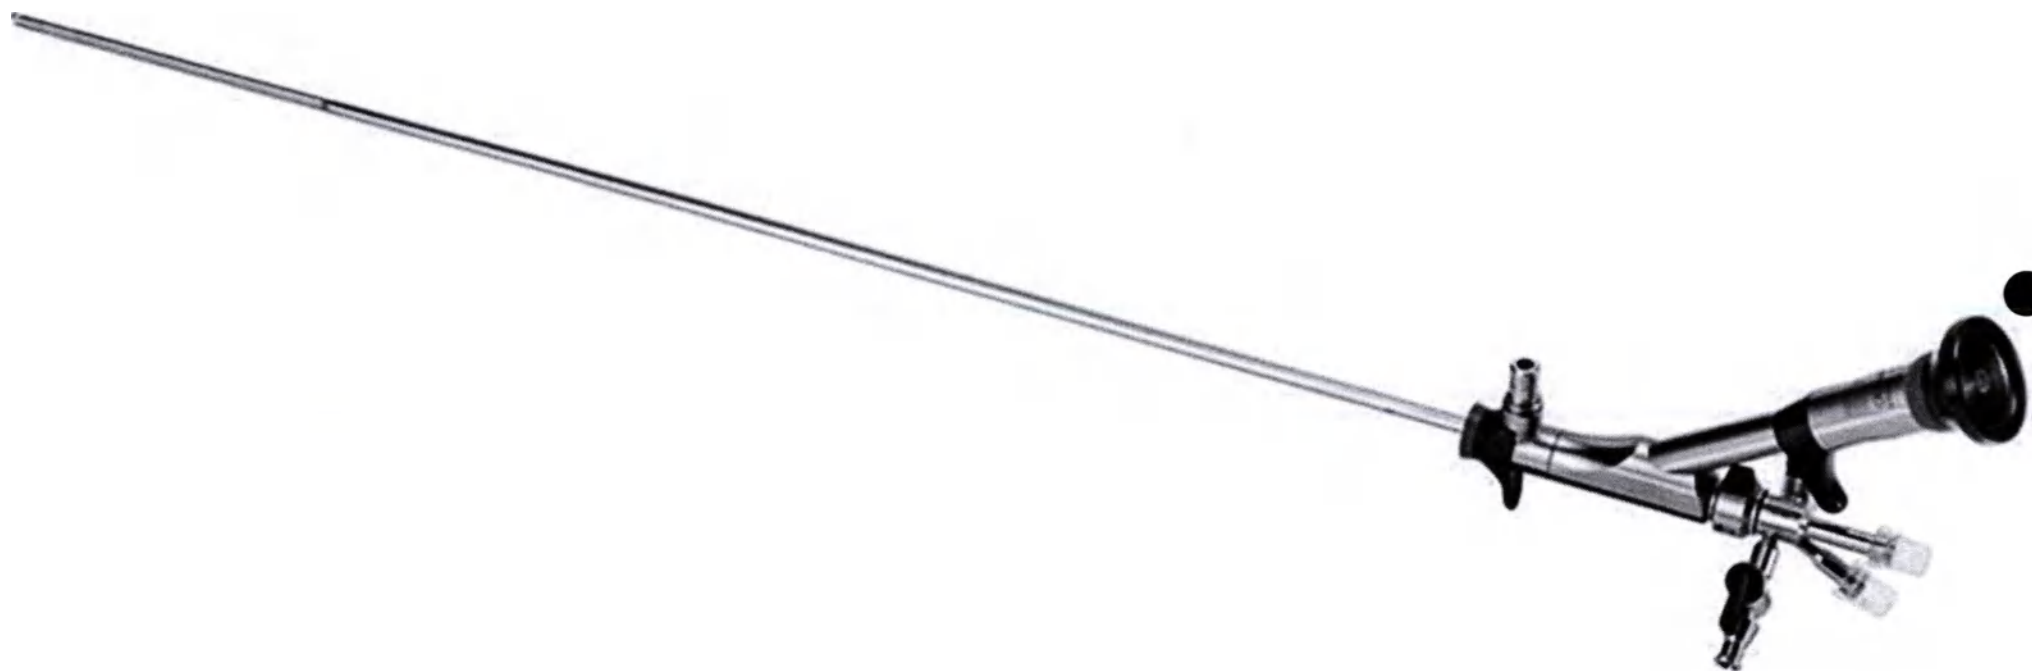

Уретероскоп WA02943A, WA02944A, WA02946A, WA29041A, WA29049A, WA29040A, WA29048A, WA29042A, WA29040B, WA29042B.

Уретероскоп WA02943A(макет маркировки)

Артикул	Уретероскоп WA02943A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

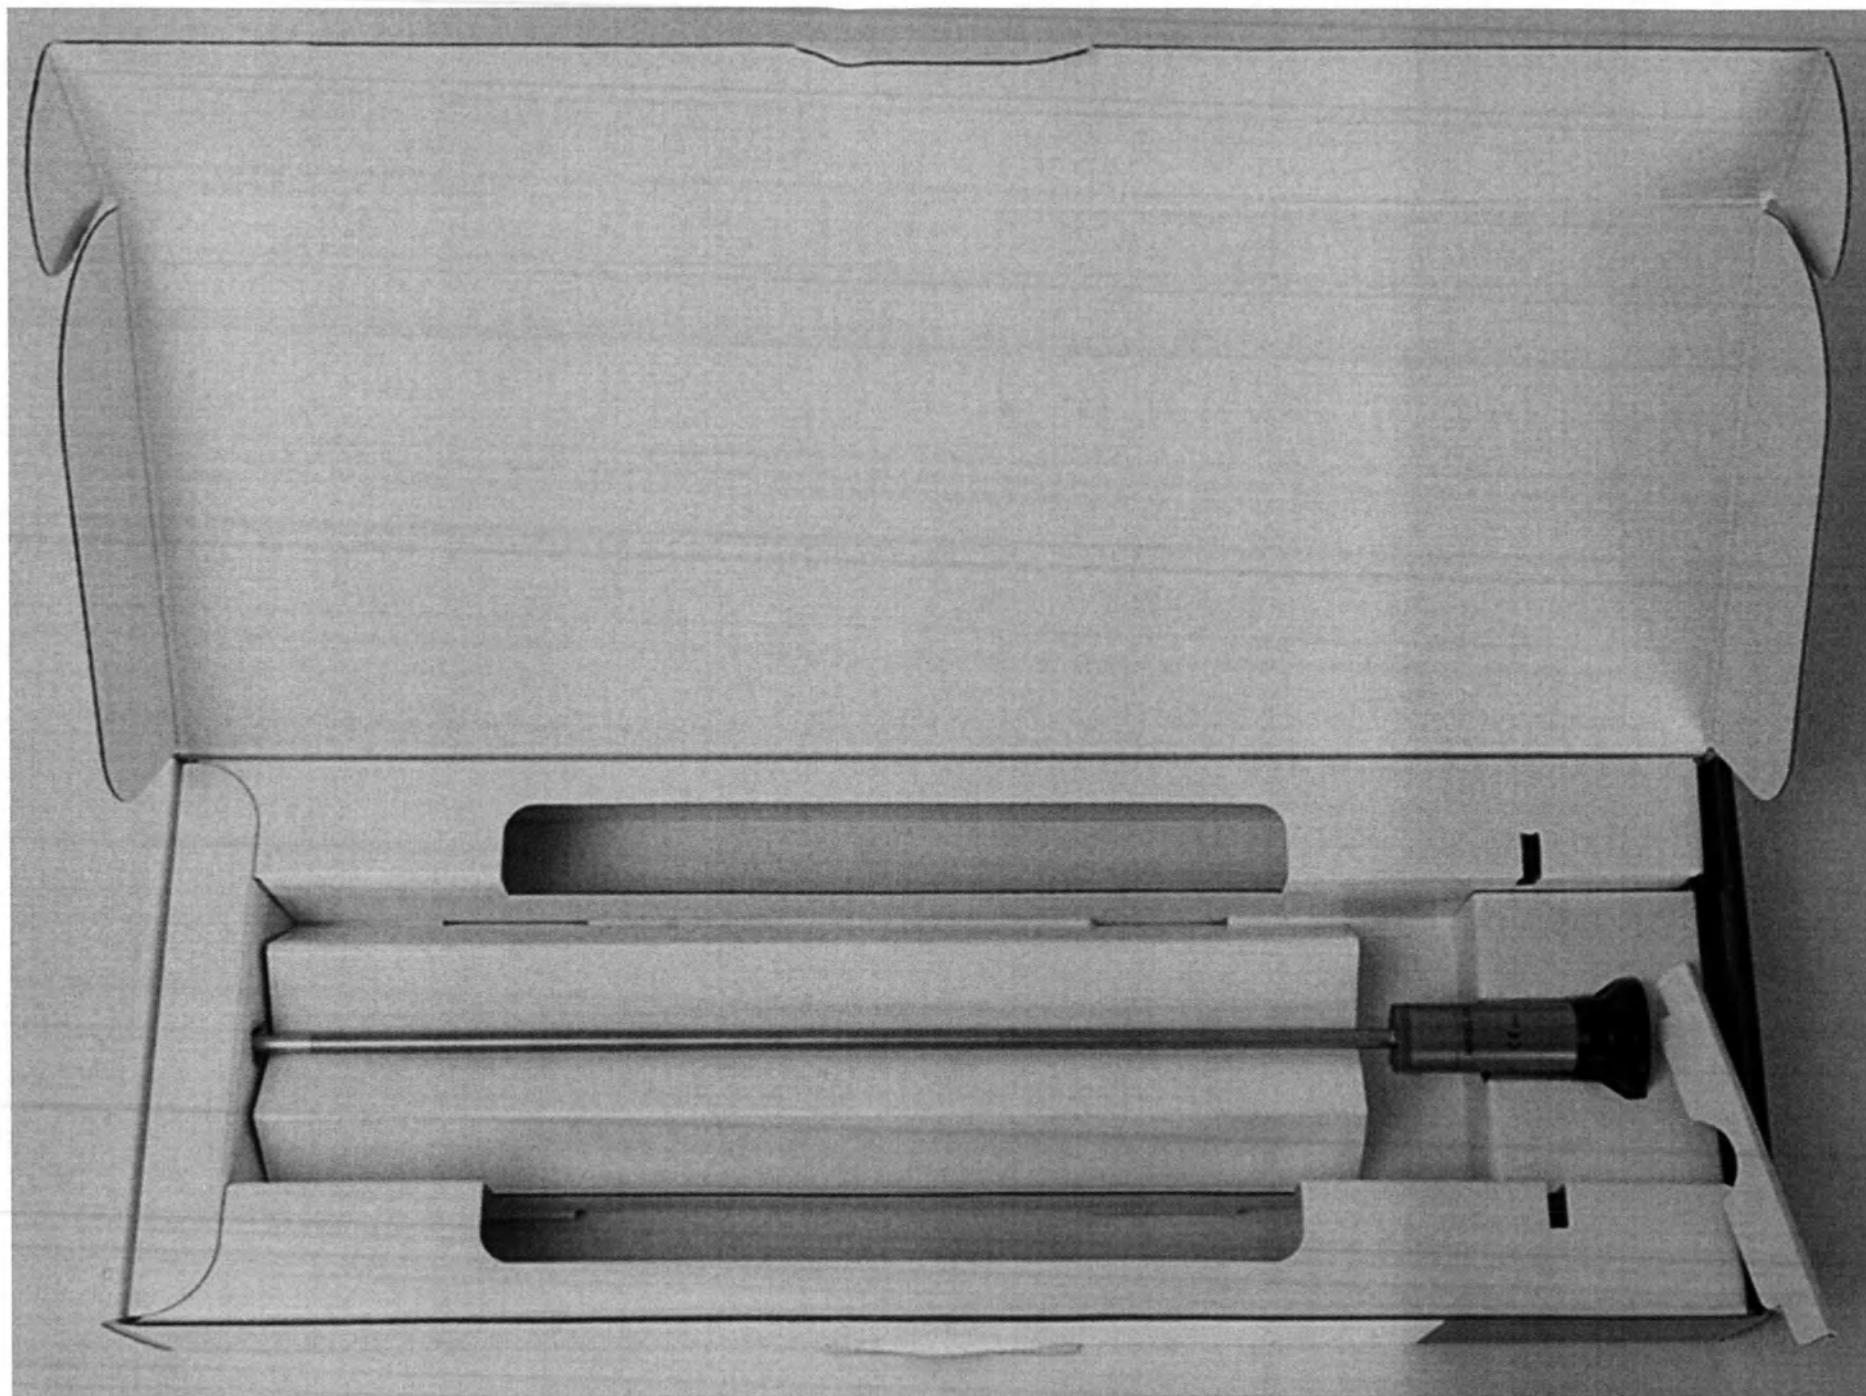


Телескоп: A2027A, A70940A, A70941A, A70942A, A70960A, A70961A, A70962A, A70963A, A7504A, A7505A, A7506A, A7507A, WA52005A, WA52006A, WA53000A, WA53005A, WA53010A, WA20021A, A81032A, WA20023A, WA4KL100, WA4KL130, WA4KL145, WA4KL500, WA4KL530, WA4KL545.

Телескоп: WA96100A (макет маркировки)


Артикул	Телескоп: WA96100A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Телескоп: WA96100A, WA96105A, WA96200A, WA96201A, WA96202A, WA96203A, WA96204A, WA96205A, WA96206A, WAIR100A, WAIR130A, WA4KA400, WA4KA430, WA4KA470, WA4KS400, WA4KS430, WA4KS431, WA4KS445, WA4KS446, WA4KS470, WA4KS471.

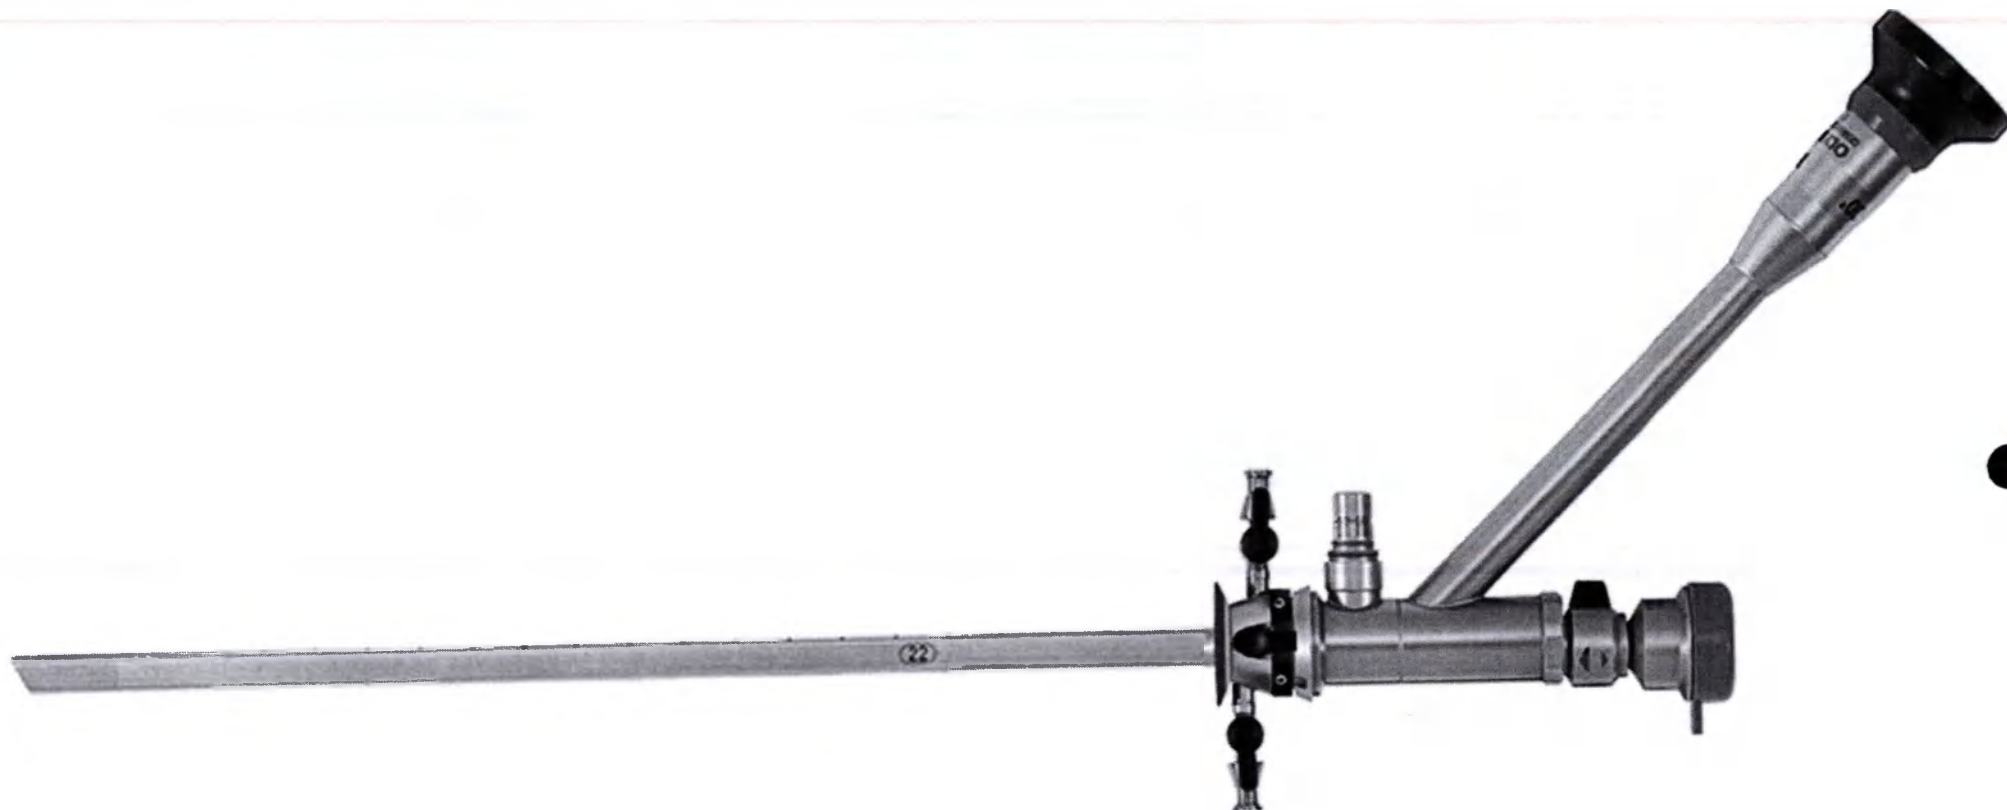


Телескоп WA33036A в комплекте с насадкой A3342, уплотнительным колпачком A4558 (3 шт.) и клапаном A00001A (3 шт.).

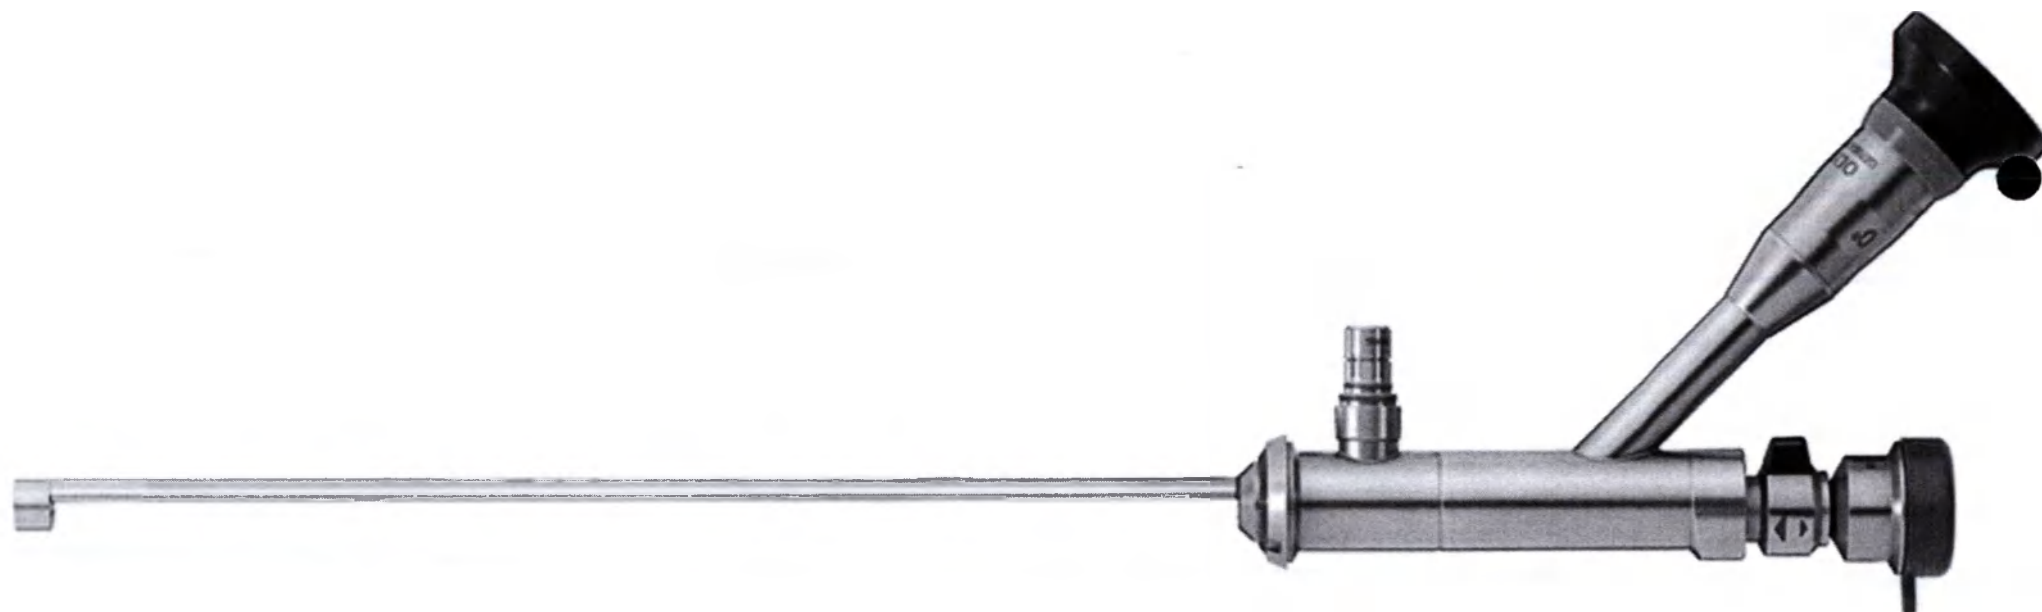


Телескоп WA31000A в комплекте с насадкой WA31001A, уплотнительным колпачком A5857 (3 шт.) и клапаном A4559 (3 шт.).

Телескоп WA31000A в комплекте с насадкой WA31001A, уплотнительным колпачком A5857 (3 шт.) и клапаном A4559 (3 шт.) (макет маркировки)

Артикул	Телескоп WA31000A в комплекте с насадкой WA31001A, уплотнительным колпачком A5857 (3 шт.) и клапаном A4559 (3 шт.)
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

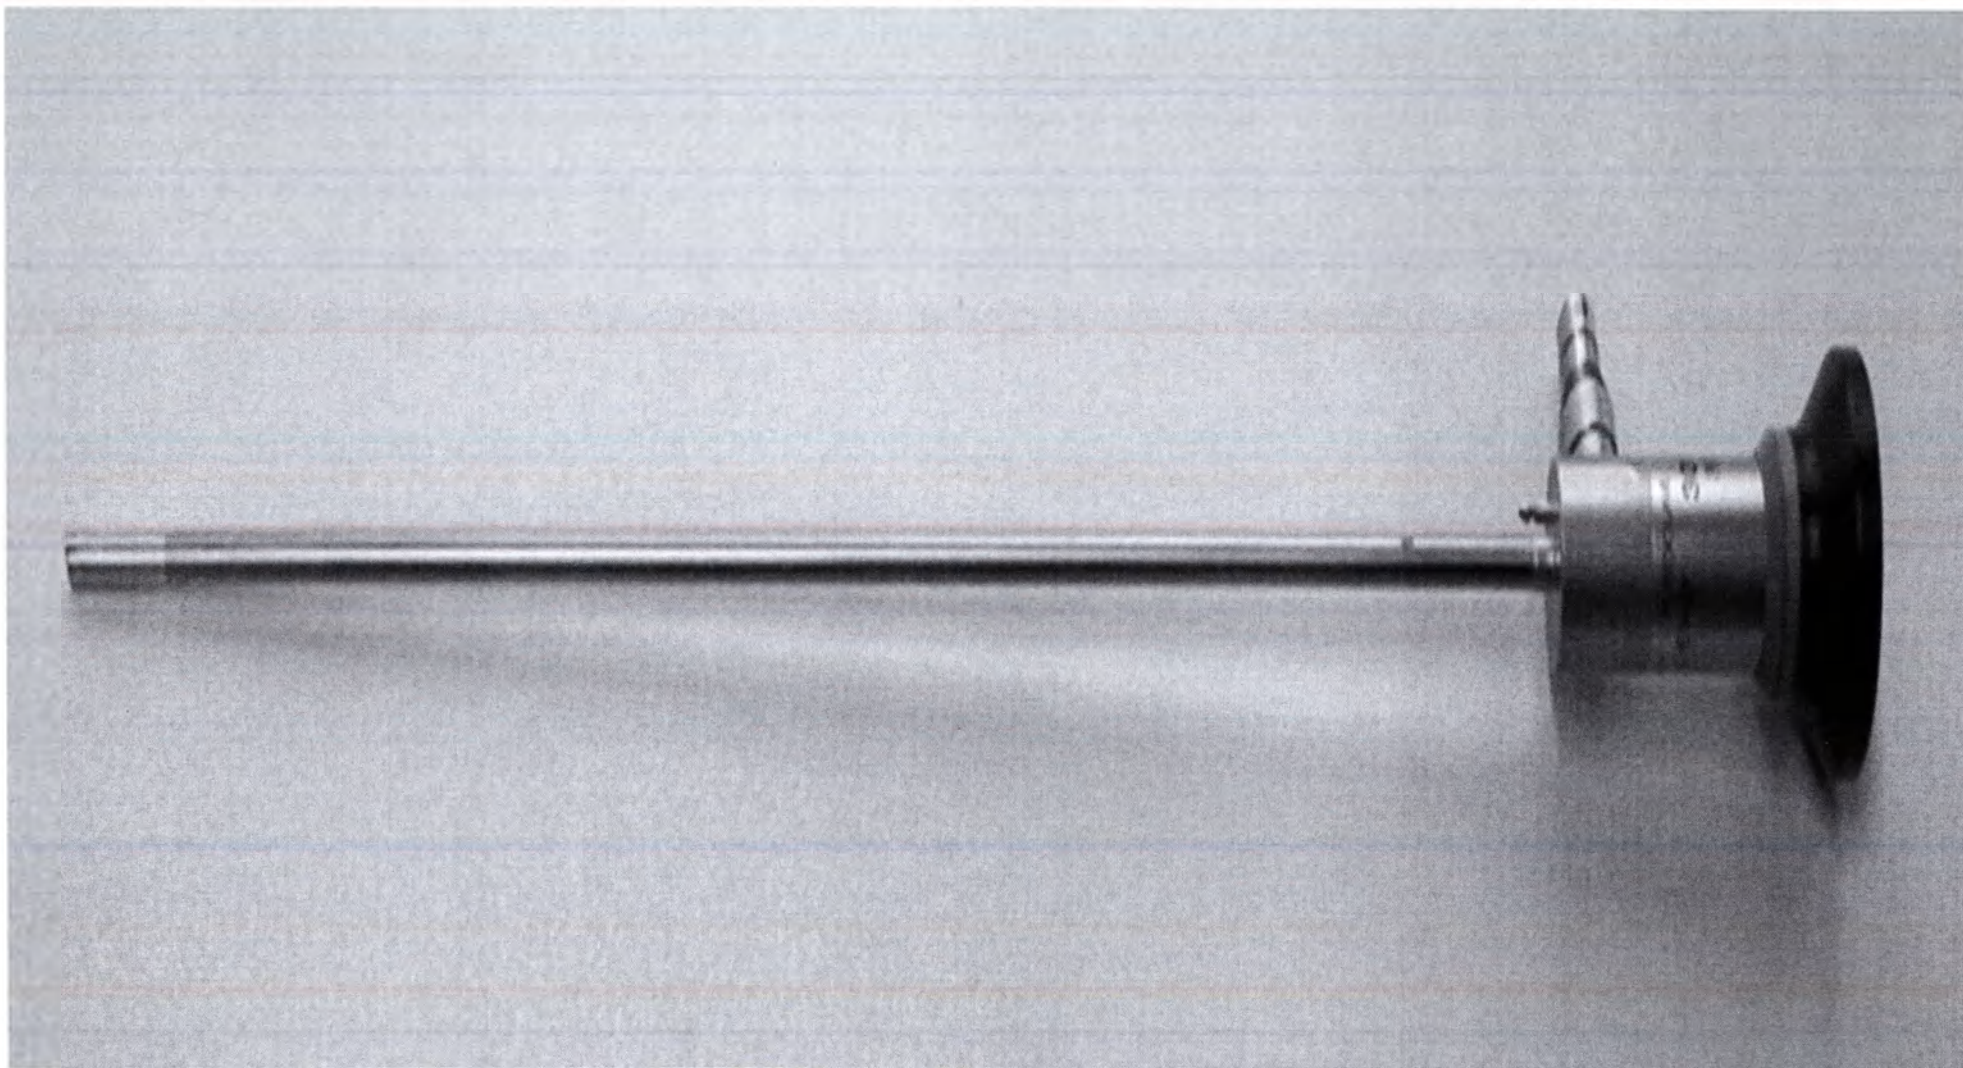

Телескоп: WA2T400A, WA2T412A, WA2T412P, WA2T430A, WA2T430P, WA2T43WA, WA2T470A, WA2T470P.

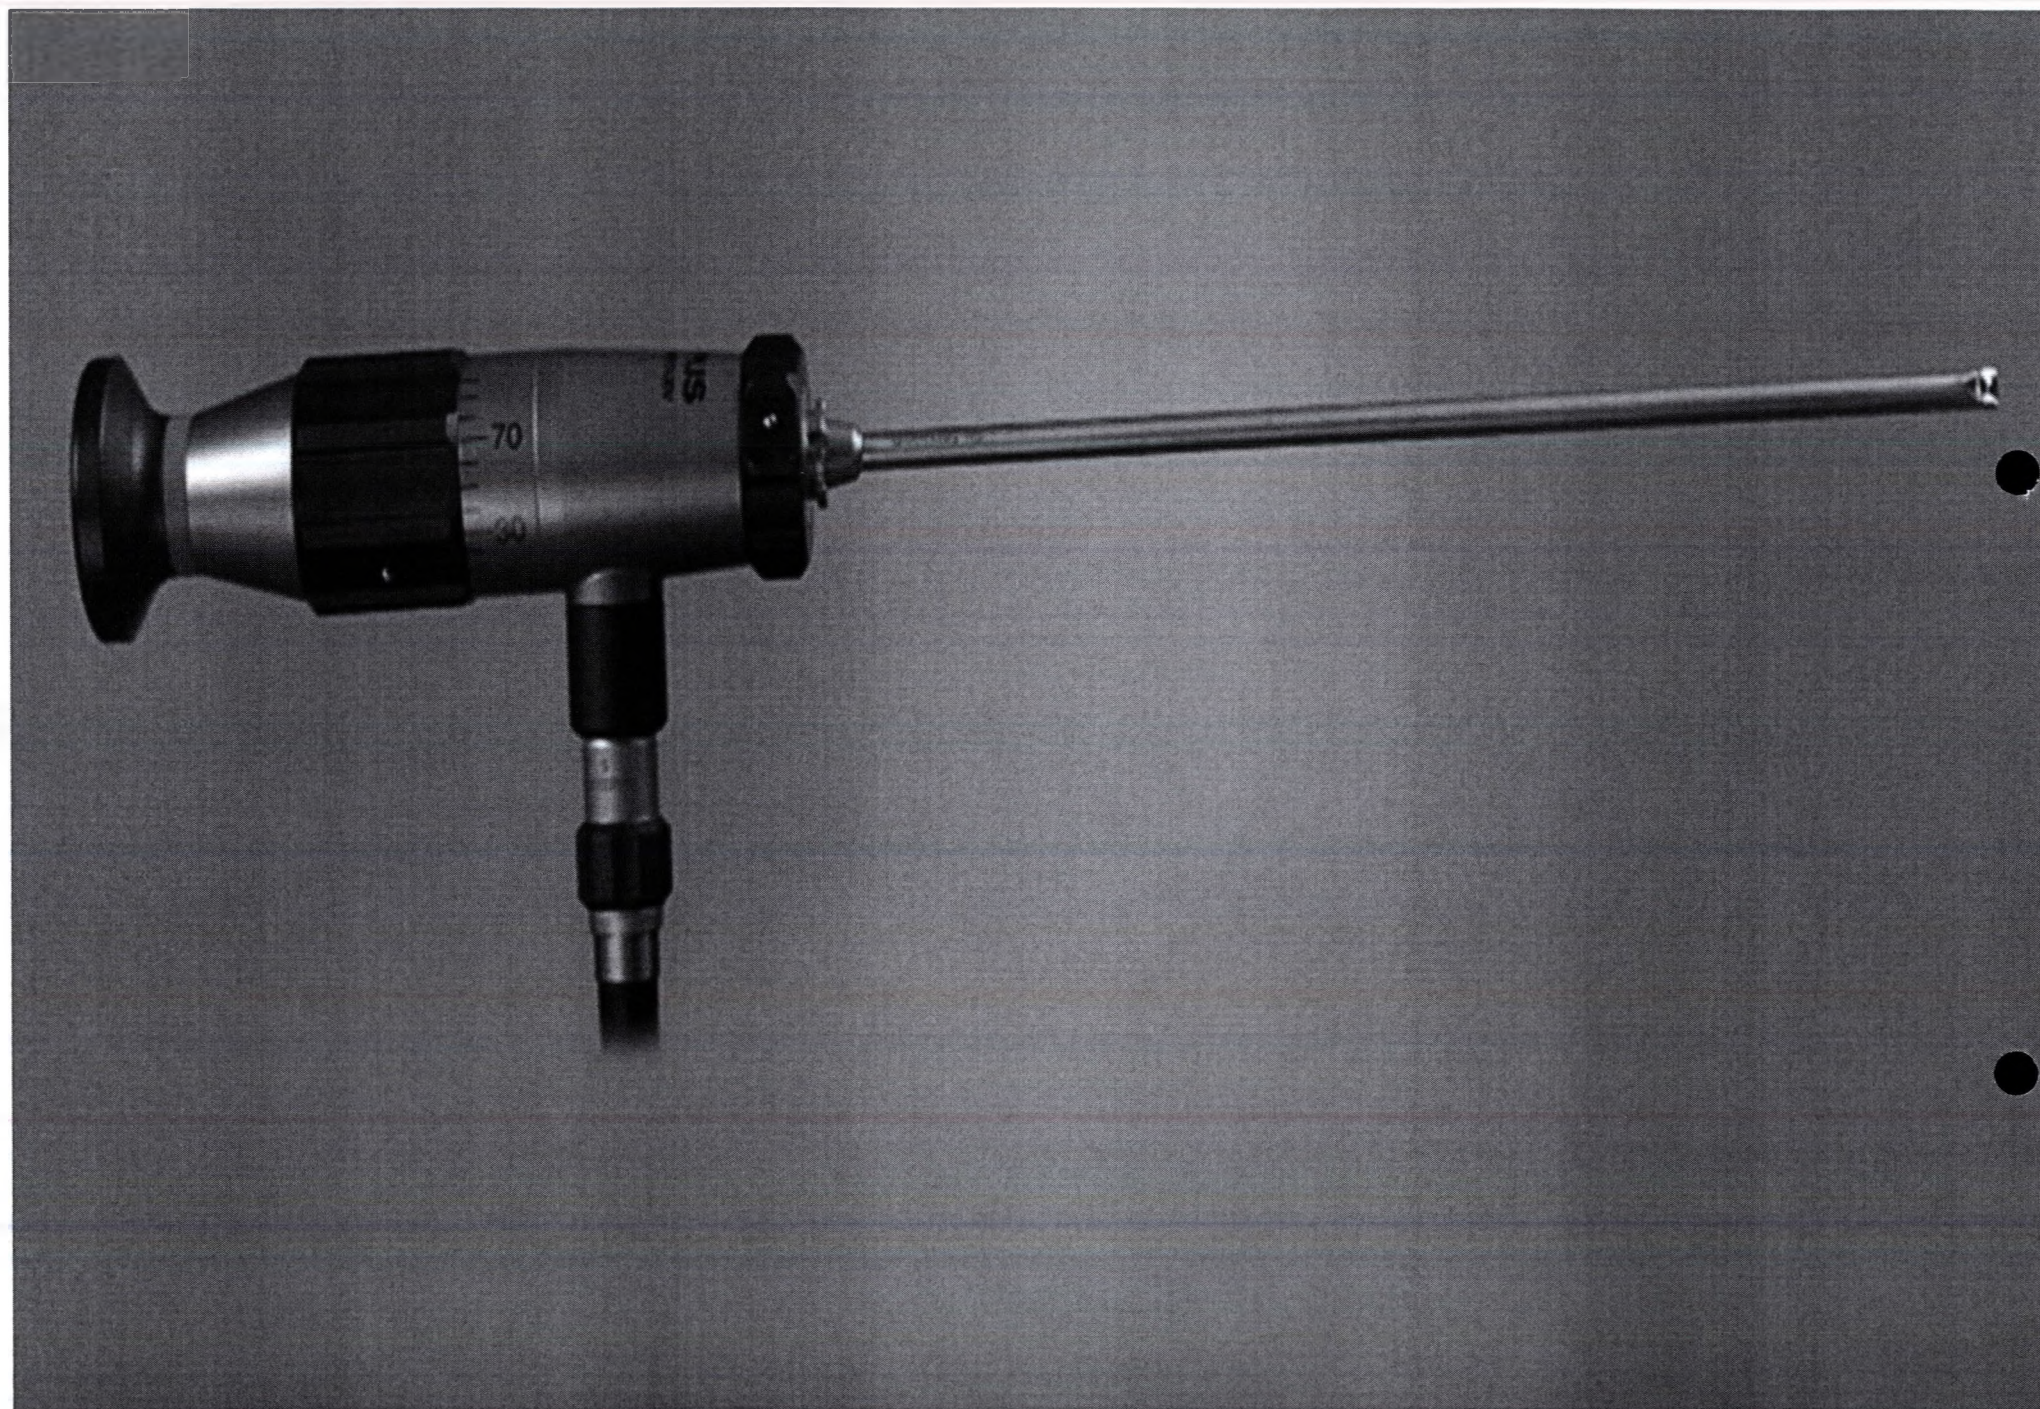

Телескоп в комплекте с защитной трубкой WA9P400A (макет маркировки)

Артикул	Телескоп в комплекте с защитной трубкой WA9P400A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Телескоп в комплекте с клапаном А52011А, А52000А, А52001А.



Телескоп в комплекте с клапаном А52011А (макет маркировки)


Артикул	Телескоп в комплекте с клапаном А52011А
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




Телескоп в комплекте с контейнером A05961A: A37025A, A46700A.

Телескоп в комплекте с контейнером A05961A(макет маркировки)


Артикул	Телескоп в комплекте с контейнером A05961A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Йбе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

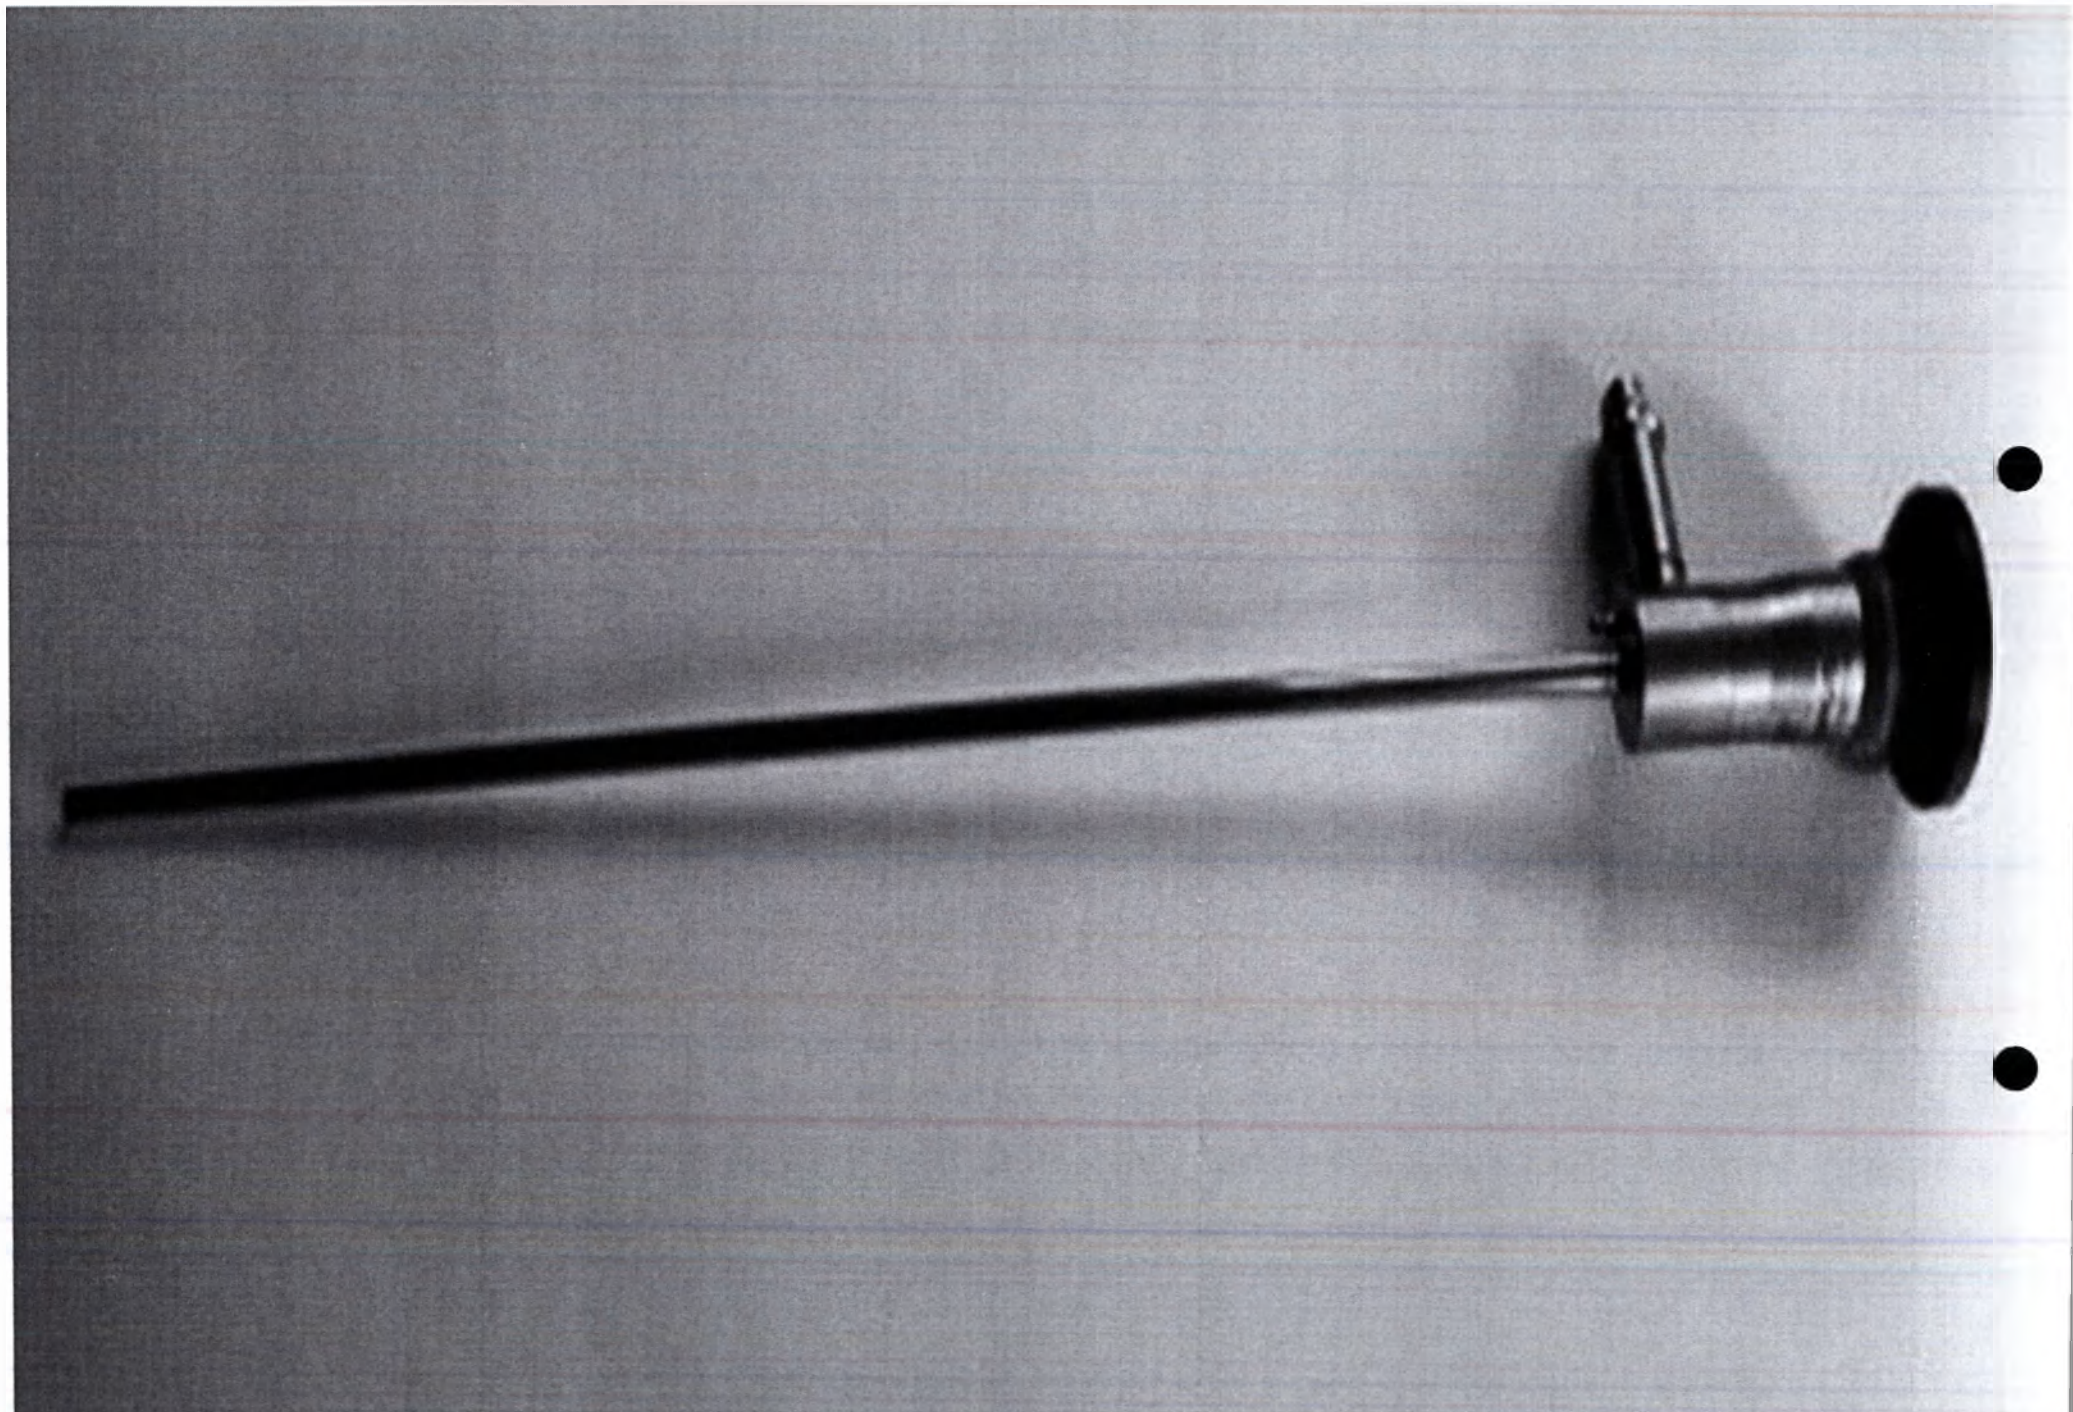

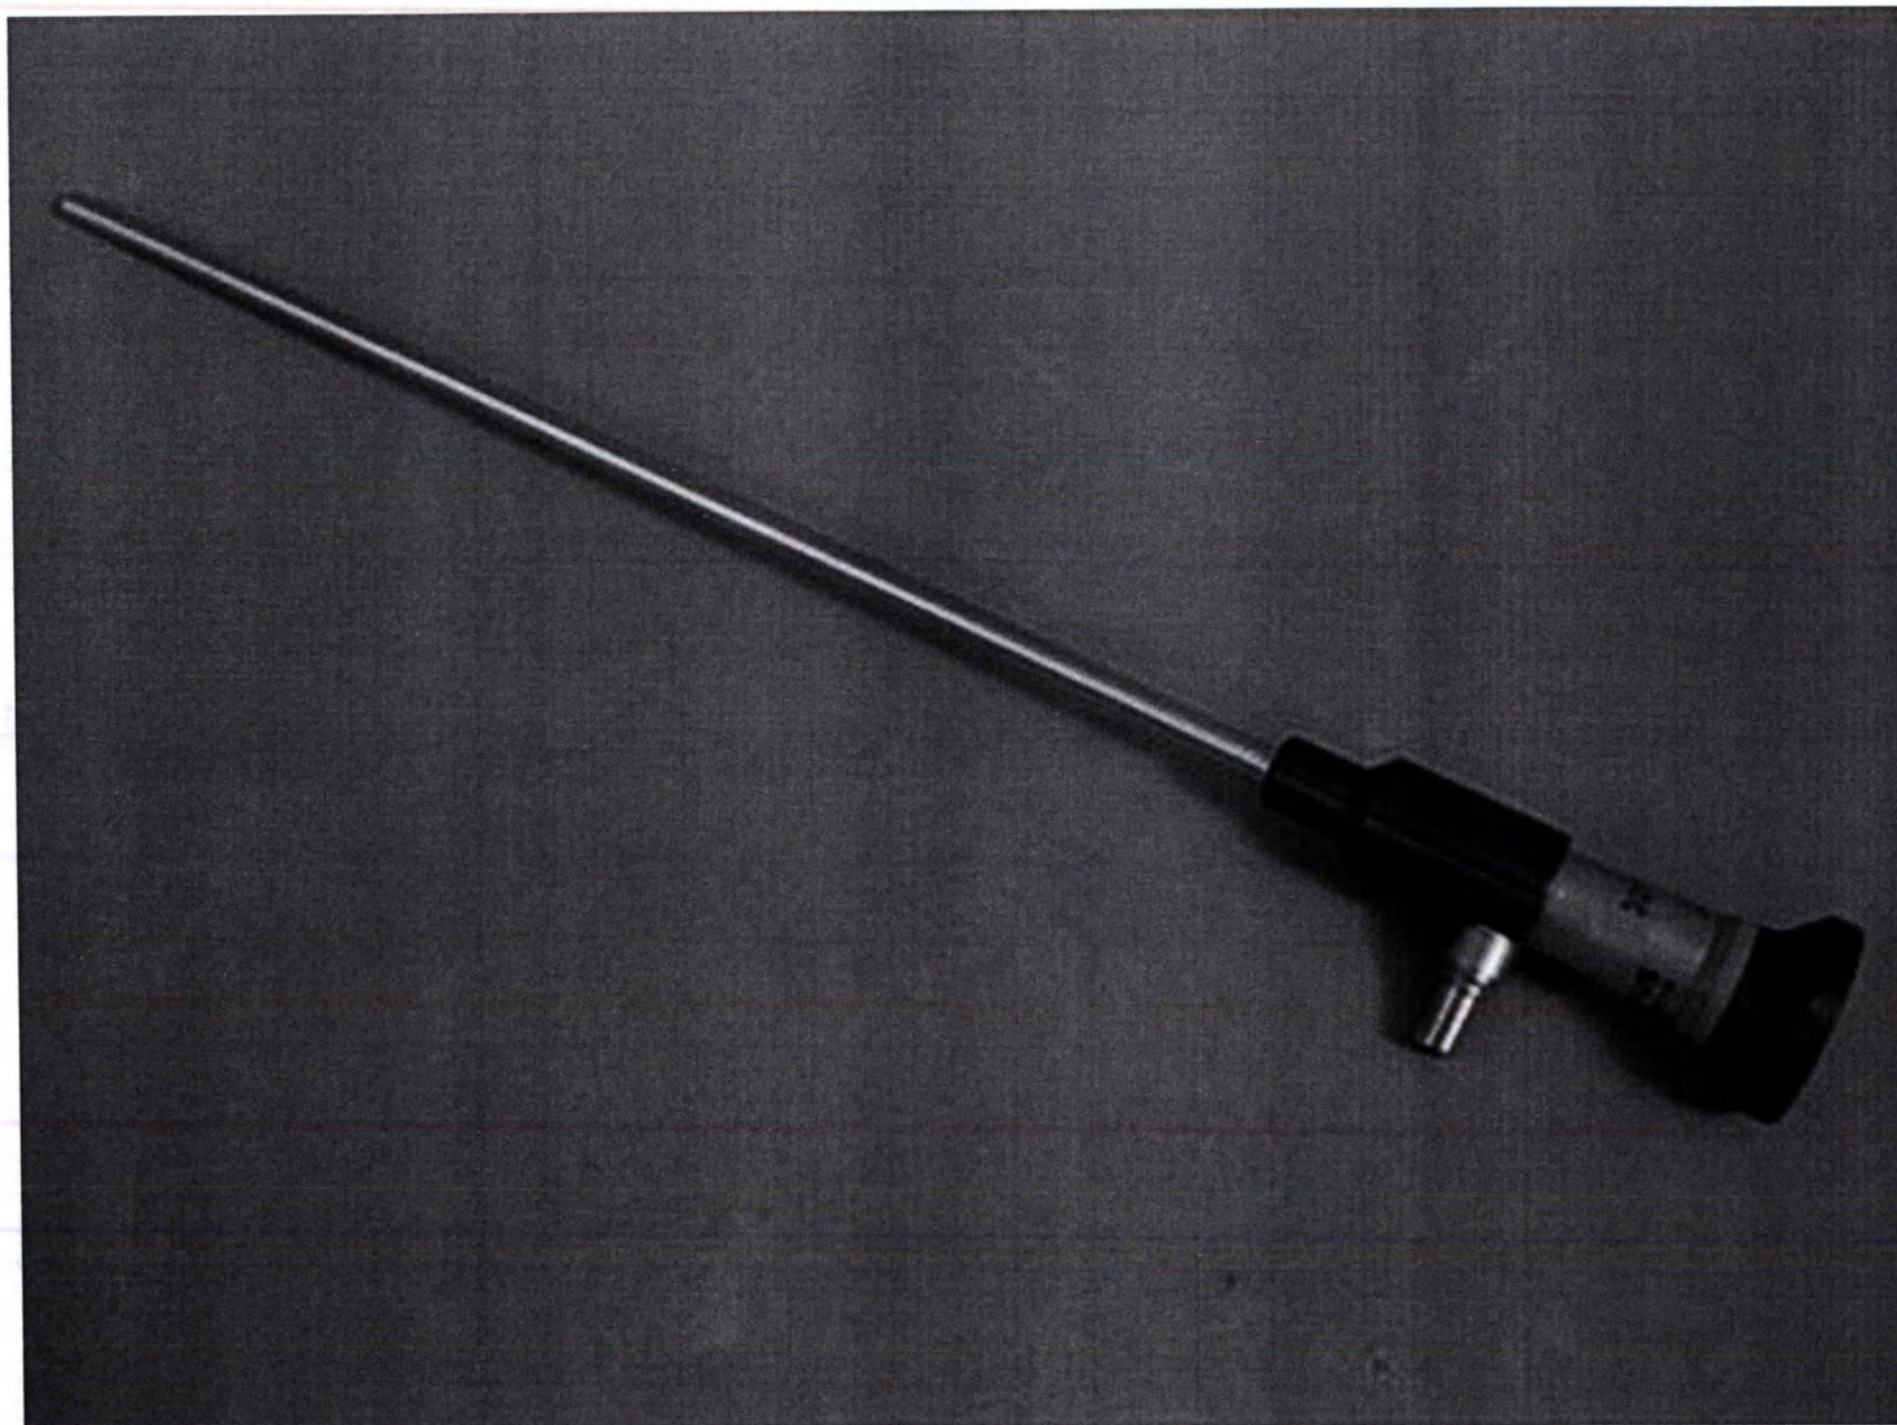

Телескоп: A22000A(макет маркировки)

Артикул	Телескоп: A22000A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

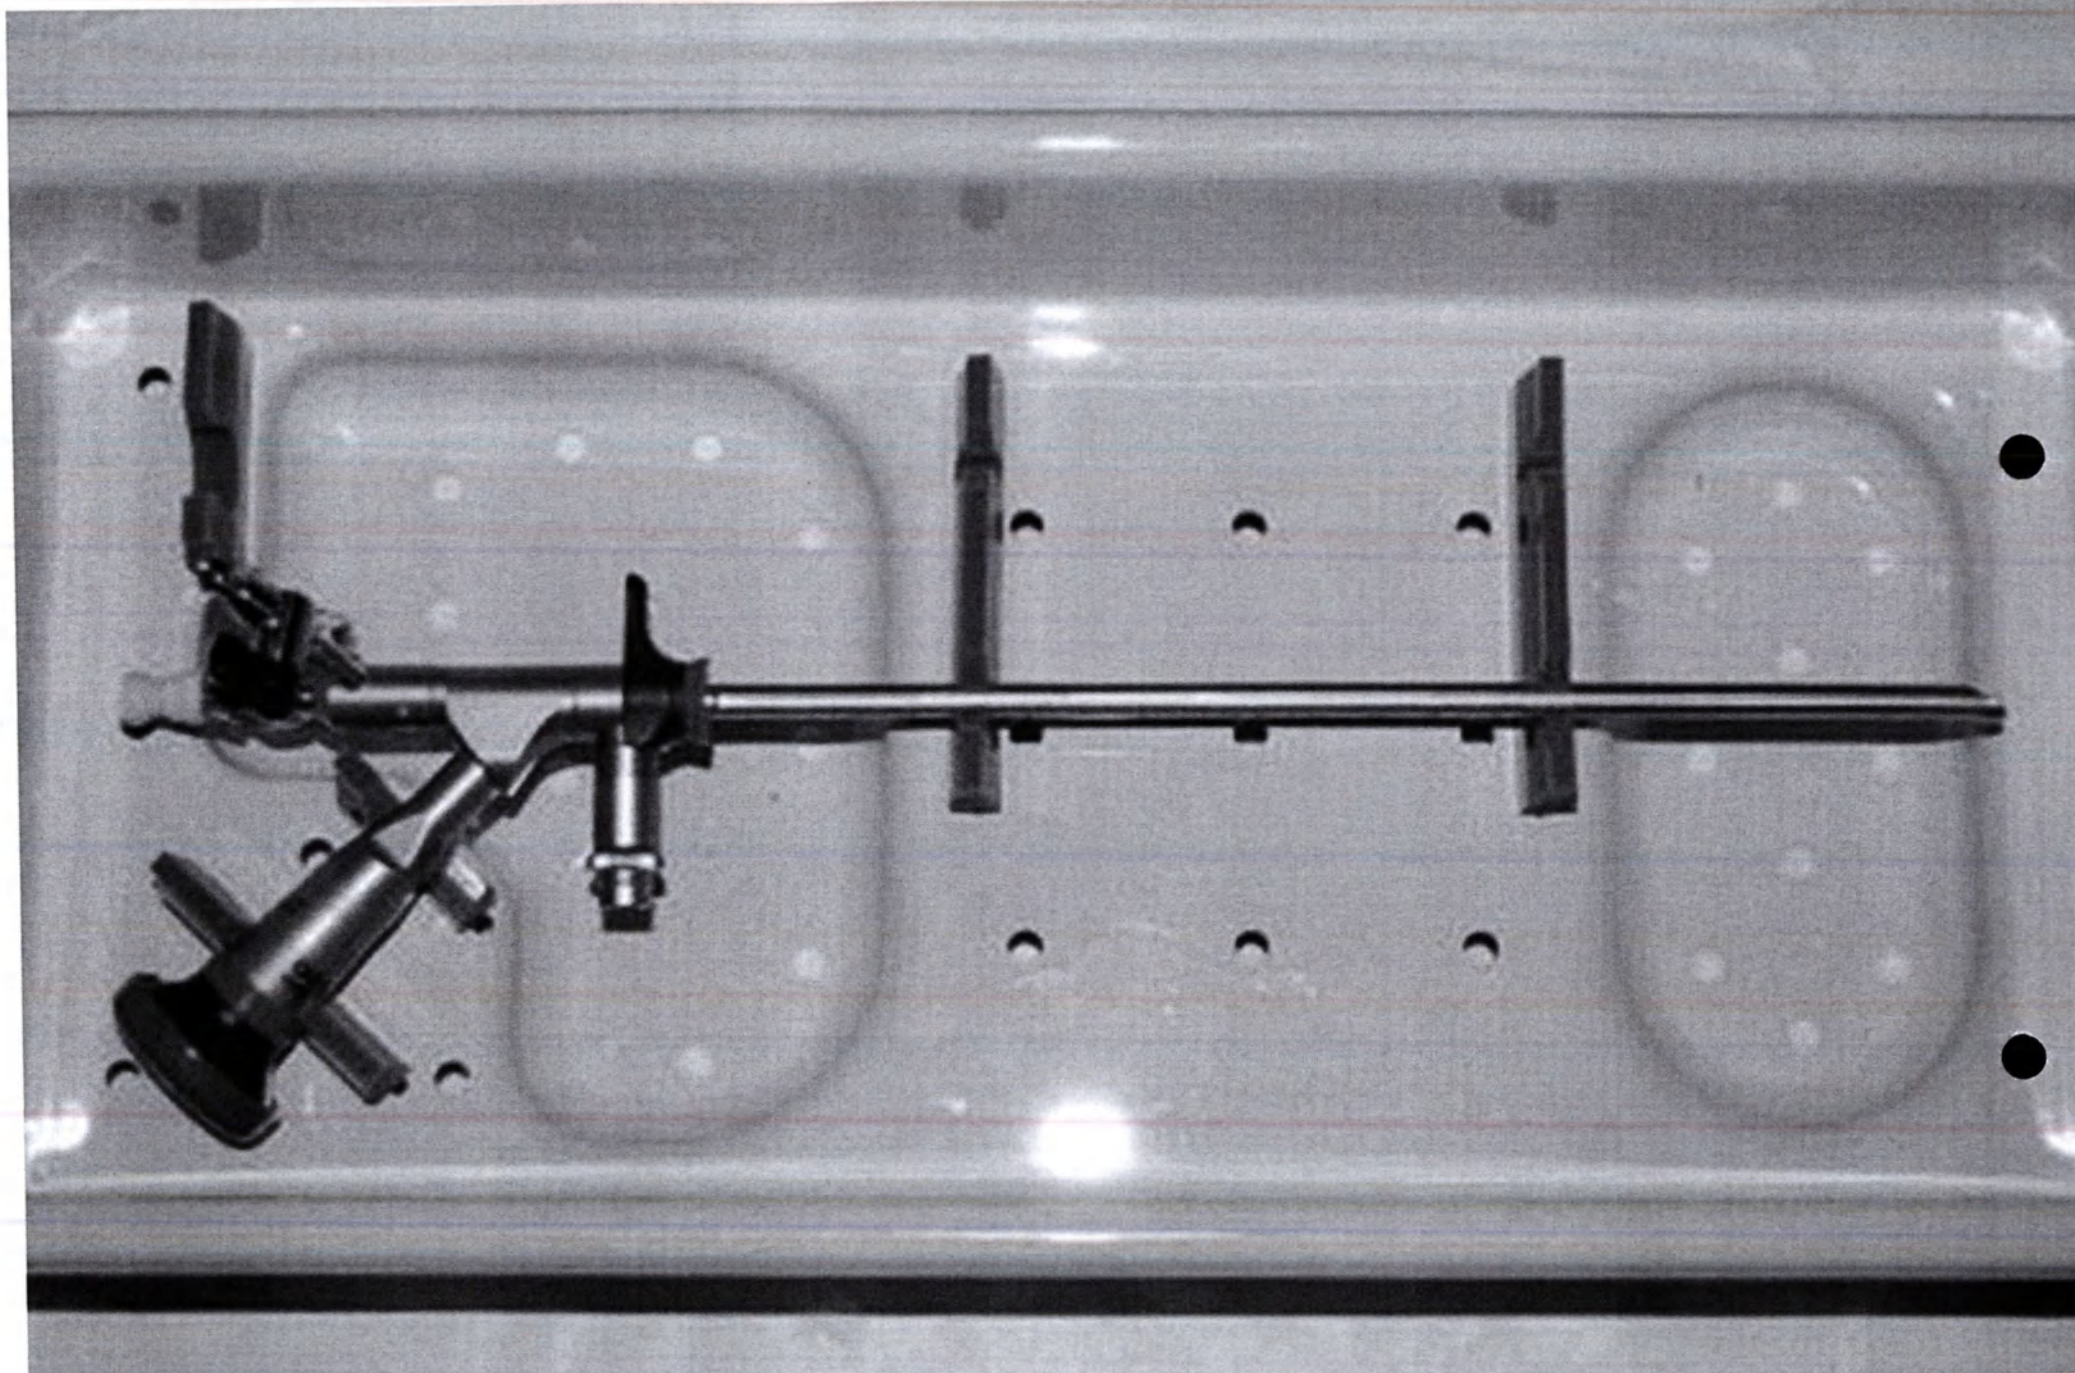

Цистоскоп в комплекте с контейнером A05961A: A20917A, A20918A, A20919A, A37026A, A37027A.

Цистоскоп в комплекте с контейнером A05961A (макет маркировки)

Артикул	Цистоскоп в комплекте с контейнером A05961A: A20917A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



A 03203 A

Адаптеры: A0100, A0101, A02958A, A0331, A3040, A3066, O0103, O0162, O0164, O0242, O0322, O0323, O0332, WA37025B, WA22870A, WA33024A, WA33026A, A3408, A0465, A0436, WA33039A, A0464, A3022, A3039, WA00331A, WA03021A, WA03022A, WA03023A, A0460, A0330, A0461, A03203A, A3201, A3202, A3213, WA03320A, A5887.

Адаптеры: A0100 (макет маркировки)


Артикул	Адаптеры: A0100
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Баллон для газа: А4663.

Баллон для газа: A4663.(макет маркировки)

Артикул	Баллон для газа: A4663.
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

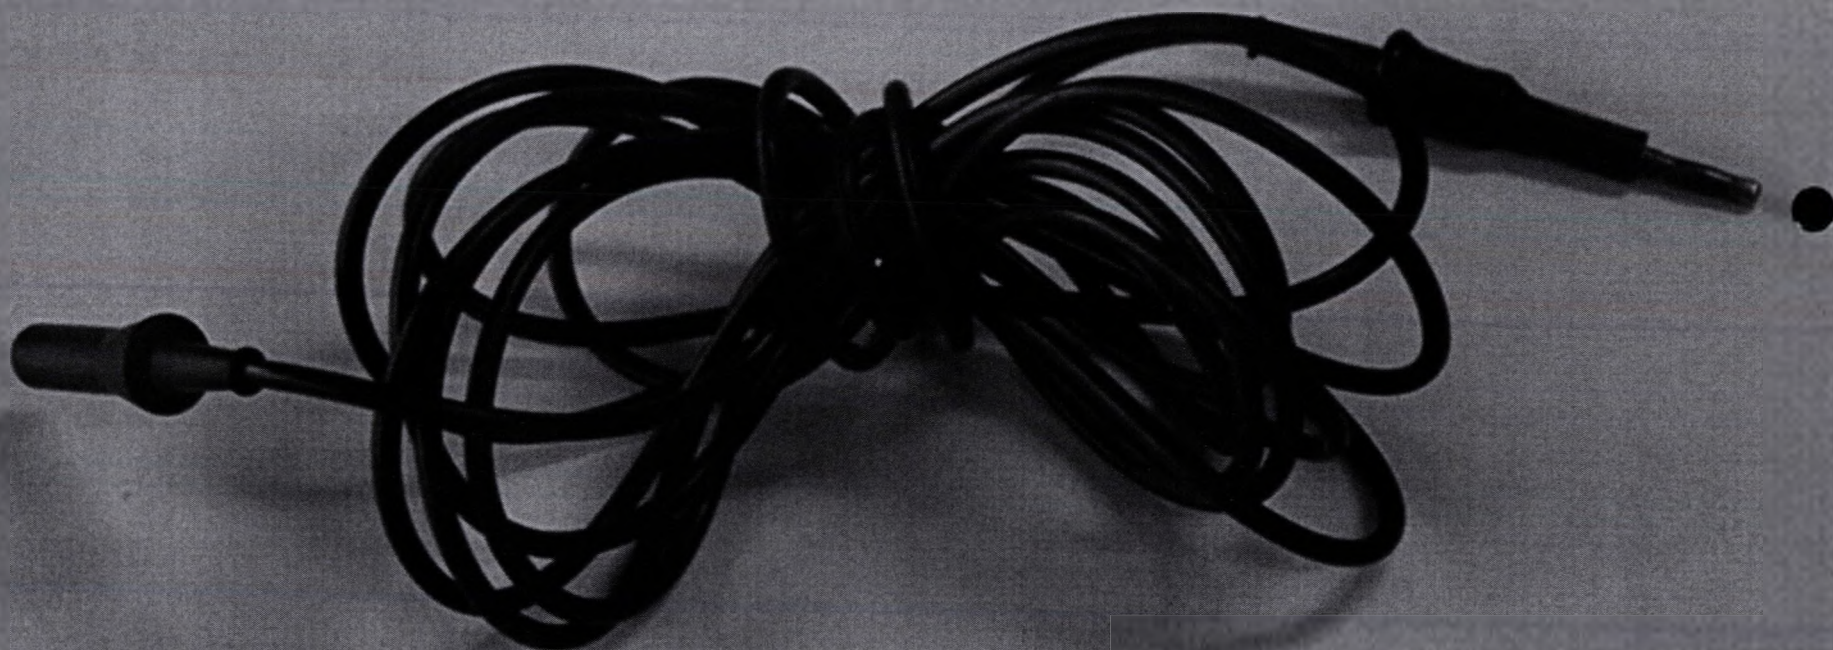

A 00011A

ВЧ-кабель: A0130.2, A0335.1, A0355, A0357, A0358, A0391, A0392, A0393, O0120.1, WA00013A, O0147.1, A0139.2, A0336.1, A2357, WA25365A, A5130, A00010A, A00011A, A00012A, WA00014A, A60000C, A60001C, A60002C, A60003C.

ВЧ-кабель: A0130.2 (макет маркировки)


Артикул	ВЧ-кабель: A0130.2
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Груша медицинская специальная: О3665

Груша медицинская специальная: О3665 (макет маркировки)


Артикул	Груша медицинская специальная: О3665
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

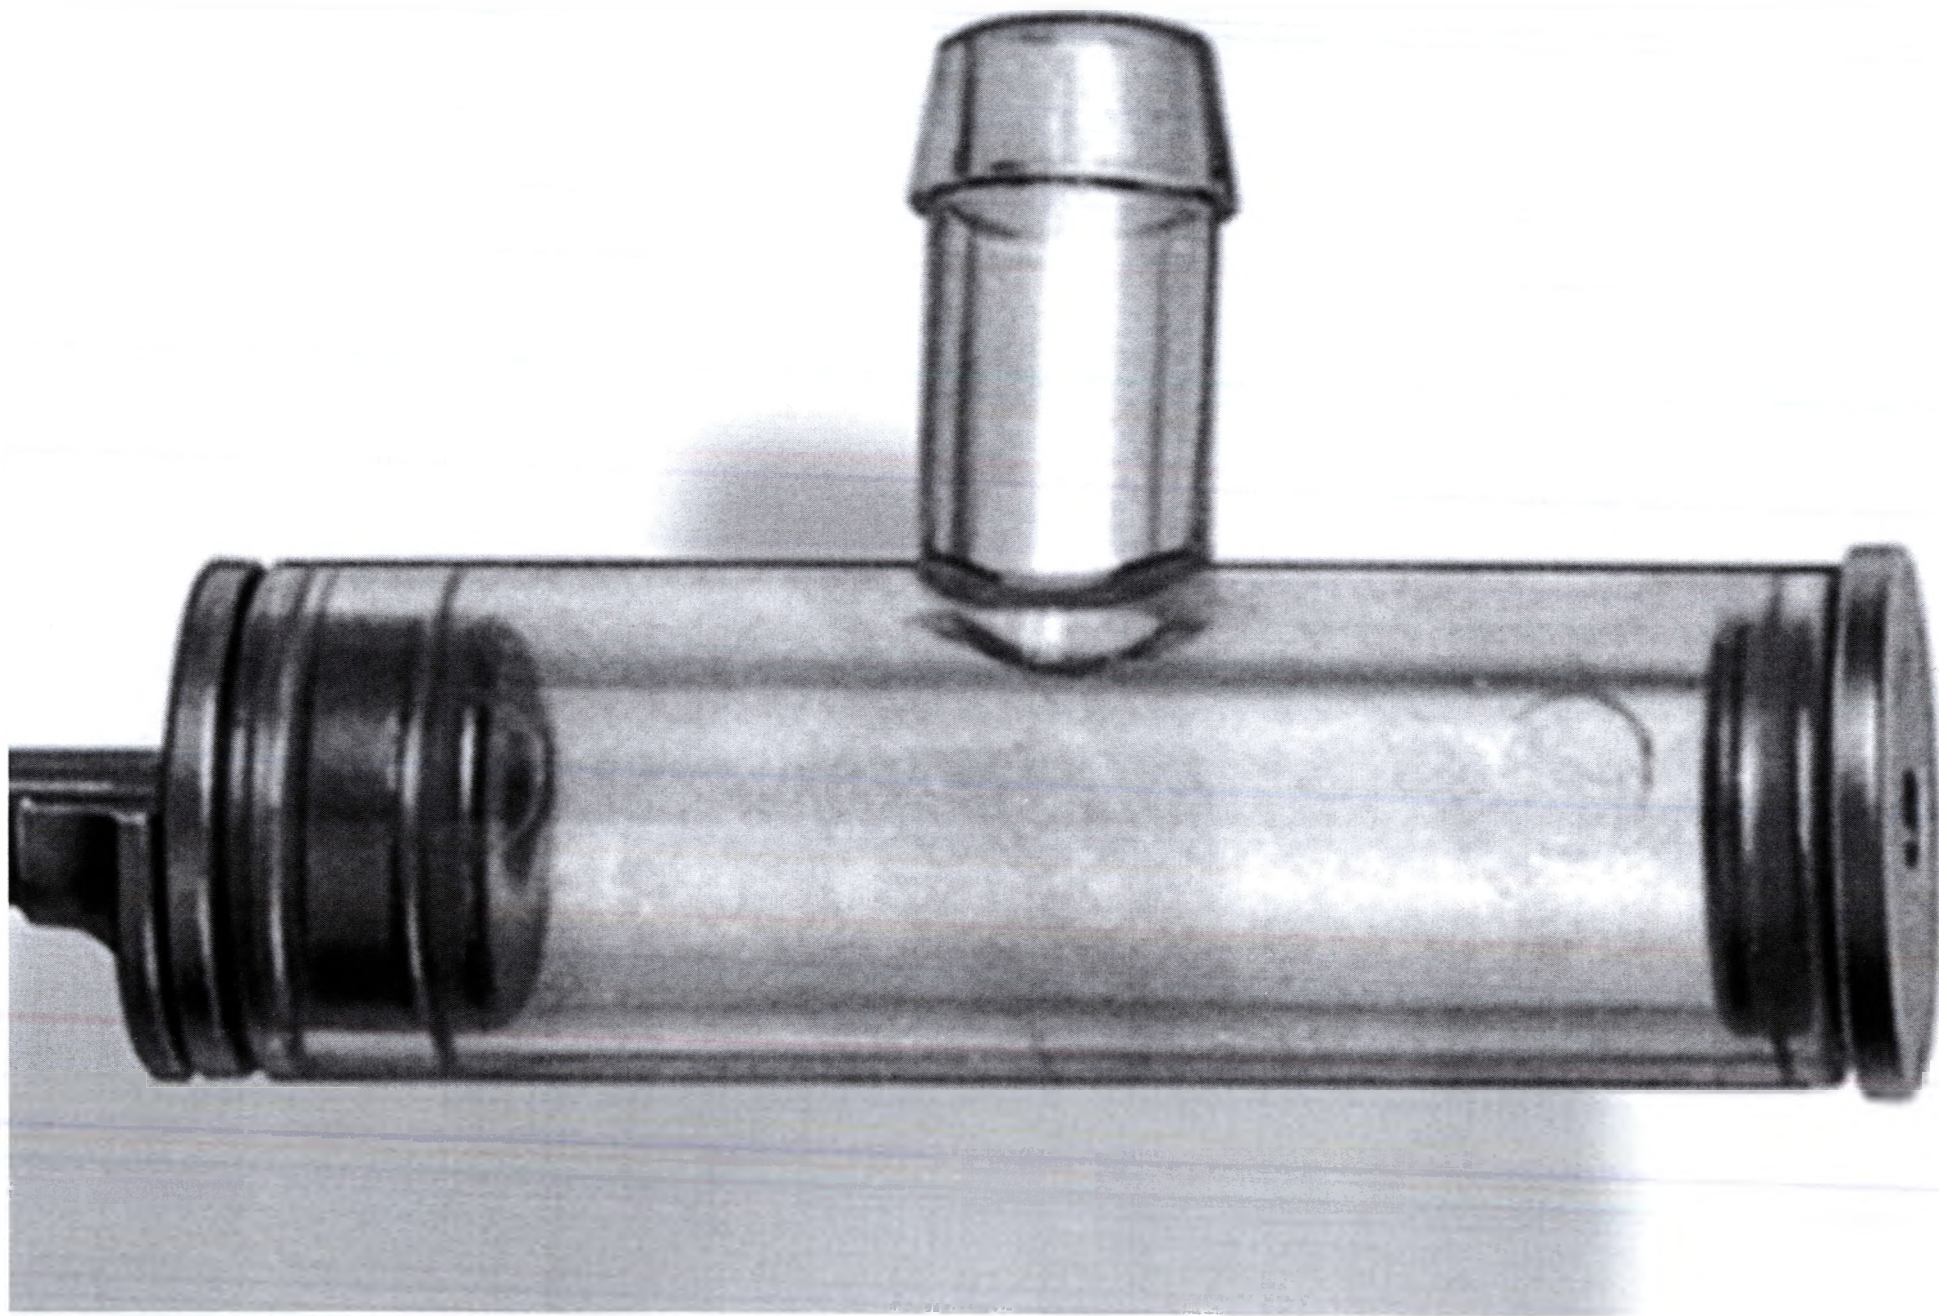

Диск стабилизационный: А2246

Диск стабилизационный: A2246 (макет маркировки)


Артикул	Диск стабилизационный. A2246
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

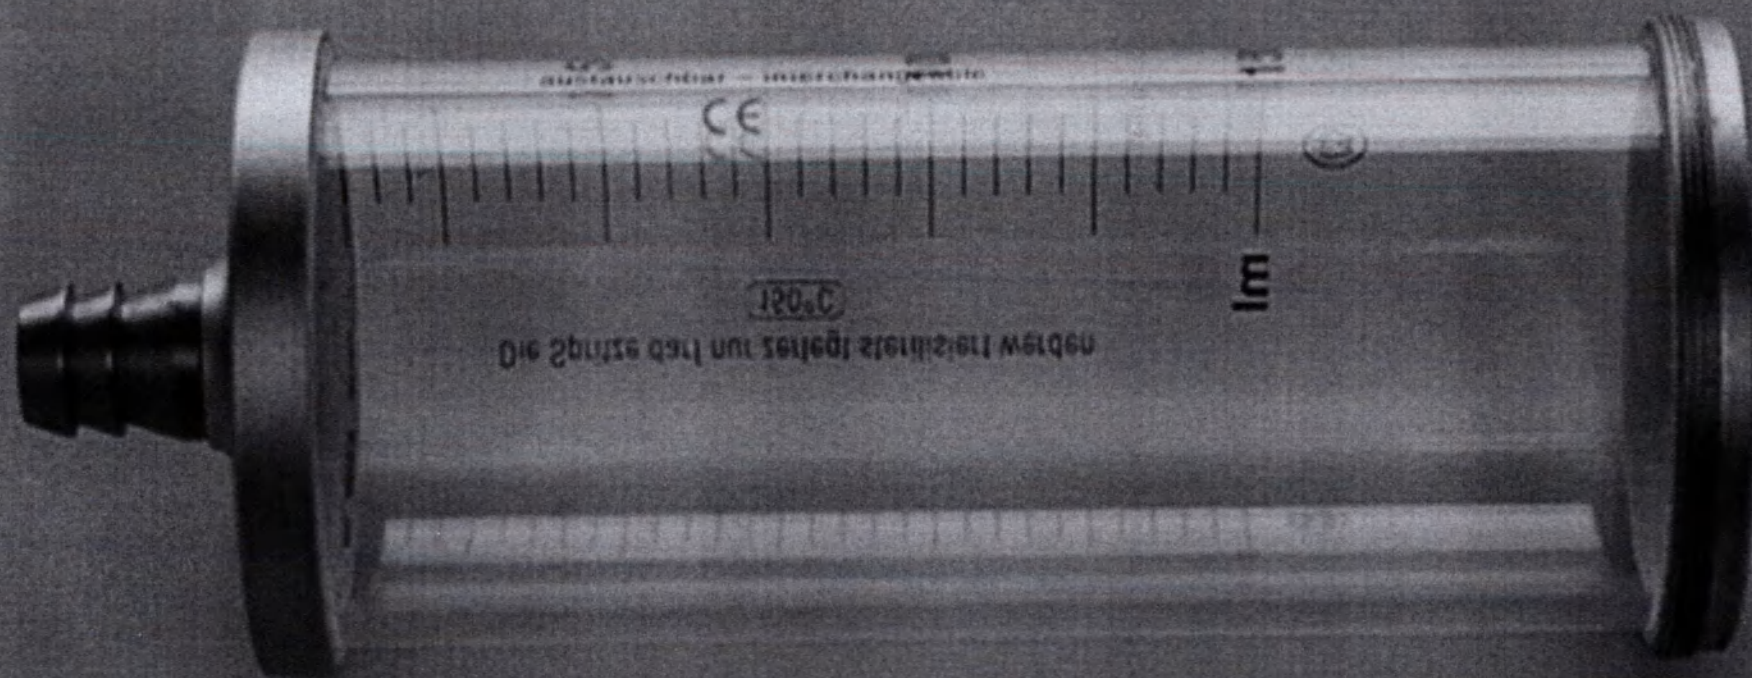

Колба для шприца: O0251, A0558, A0559.

Колба для шприца: O0251(макет маркировки)


Артикул	Колба для шприца: O0251
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

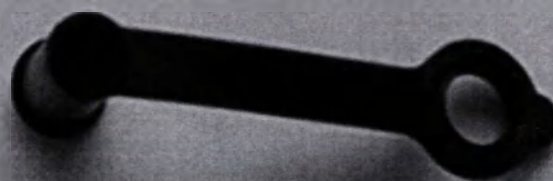

Колпачок уплотнительный: A0206 (10 шт.), A0313 (10 шт.), A0344 (10 шт.), A03440A (10 шт.), A5442 (10 шт.), O0131 (10 шт.), O0258 (10 шт.), O0201(10 шт.), A0298 (6 шт.), WA63821A (20 шт.), WA00387A (10 шт.), A0223 (10 шт.), WA58035A (10 шт.), A0205 (10 шт.), A0299 (10 шт.), A0282 (10 шт.), WA22880A (5 шт.), A0287 (6 шт.), A0286 (6 шт.), A0310 (10 шт.), A7593, A0353 (12 шт.), A0400, A4558, A5848, A5857, A5858, A70959A.

Колпачок уплотнительный: A0206 (10 шт.) (макет маркировки)

Артикул	Колпачок уплотнительный: A0206 (10 шт.)
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

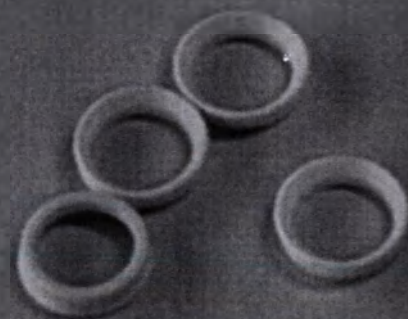


A00481A

Кольцо уплотнительное: WA51187A (10 шт.), WA51188A (10 шт.), A5275 (5 шт.), A00507A, A0468 (10 шт.), A0420 (10 шт.), A5856, WA39006A, WA39007A, WA39008A, A4069, A00481A, A00482A, A00483A.


Кольцо уплотнительное: WA51187A (10 шт.) (макет маркировки)

Артикул	Кольцо уплотнительное: WA51187A (10 шт.)
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

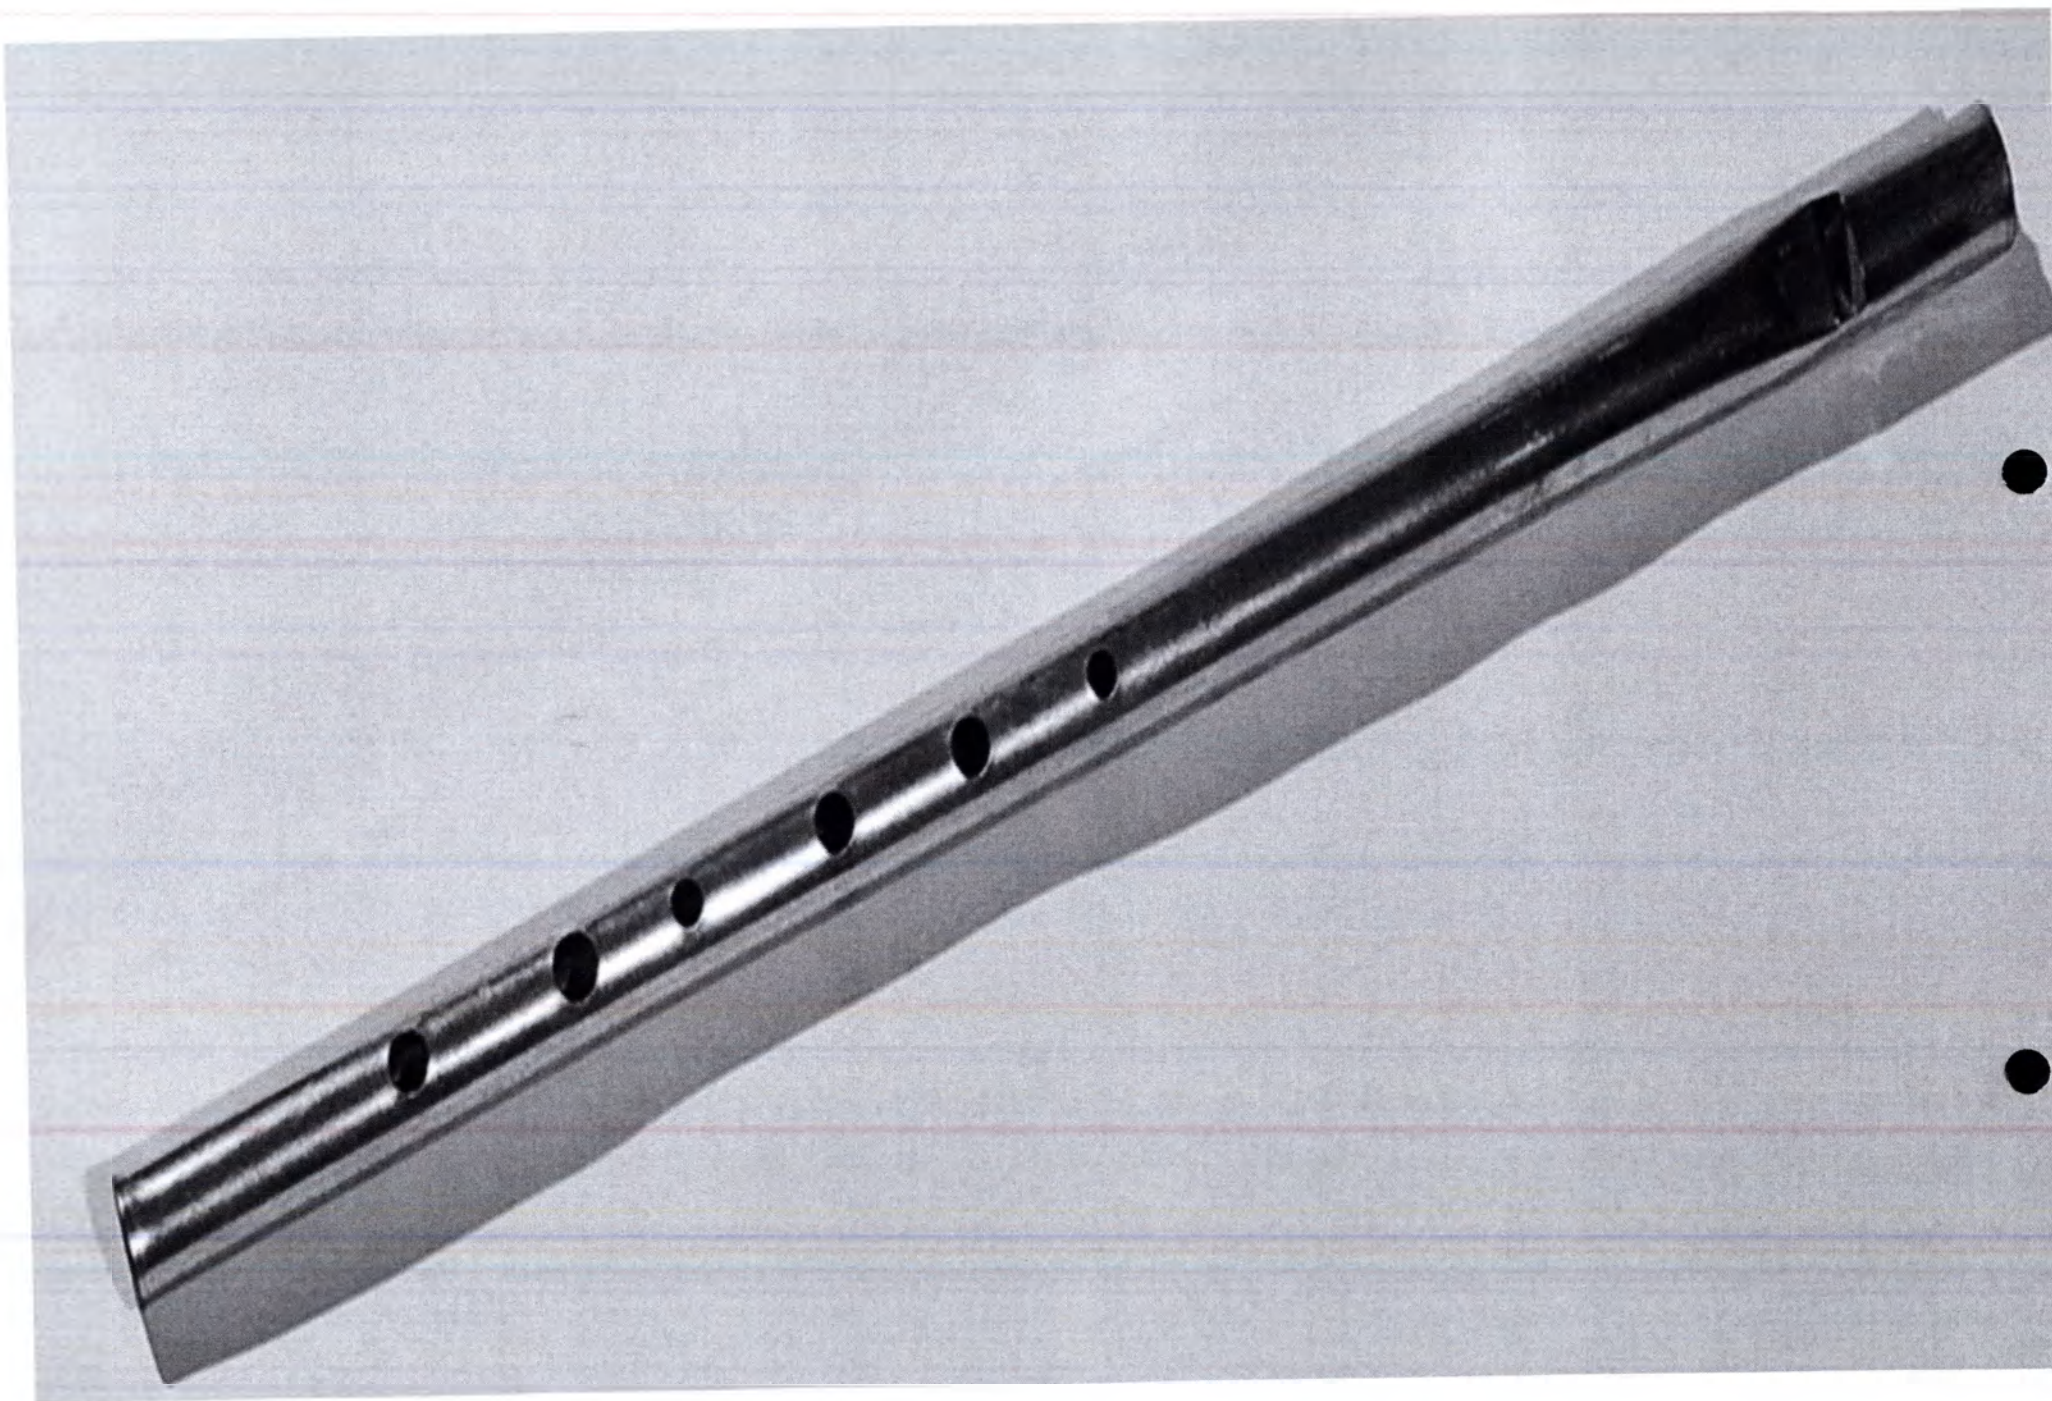


Контейнер для дезинфекции: A0285. (макет маркировки)

Артикул	Контейнер для дезинфекции: A0285.
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

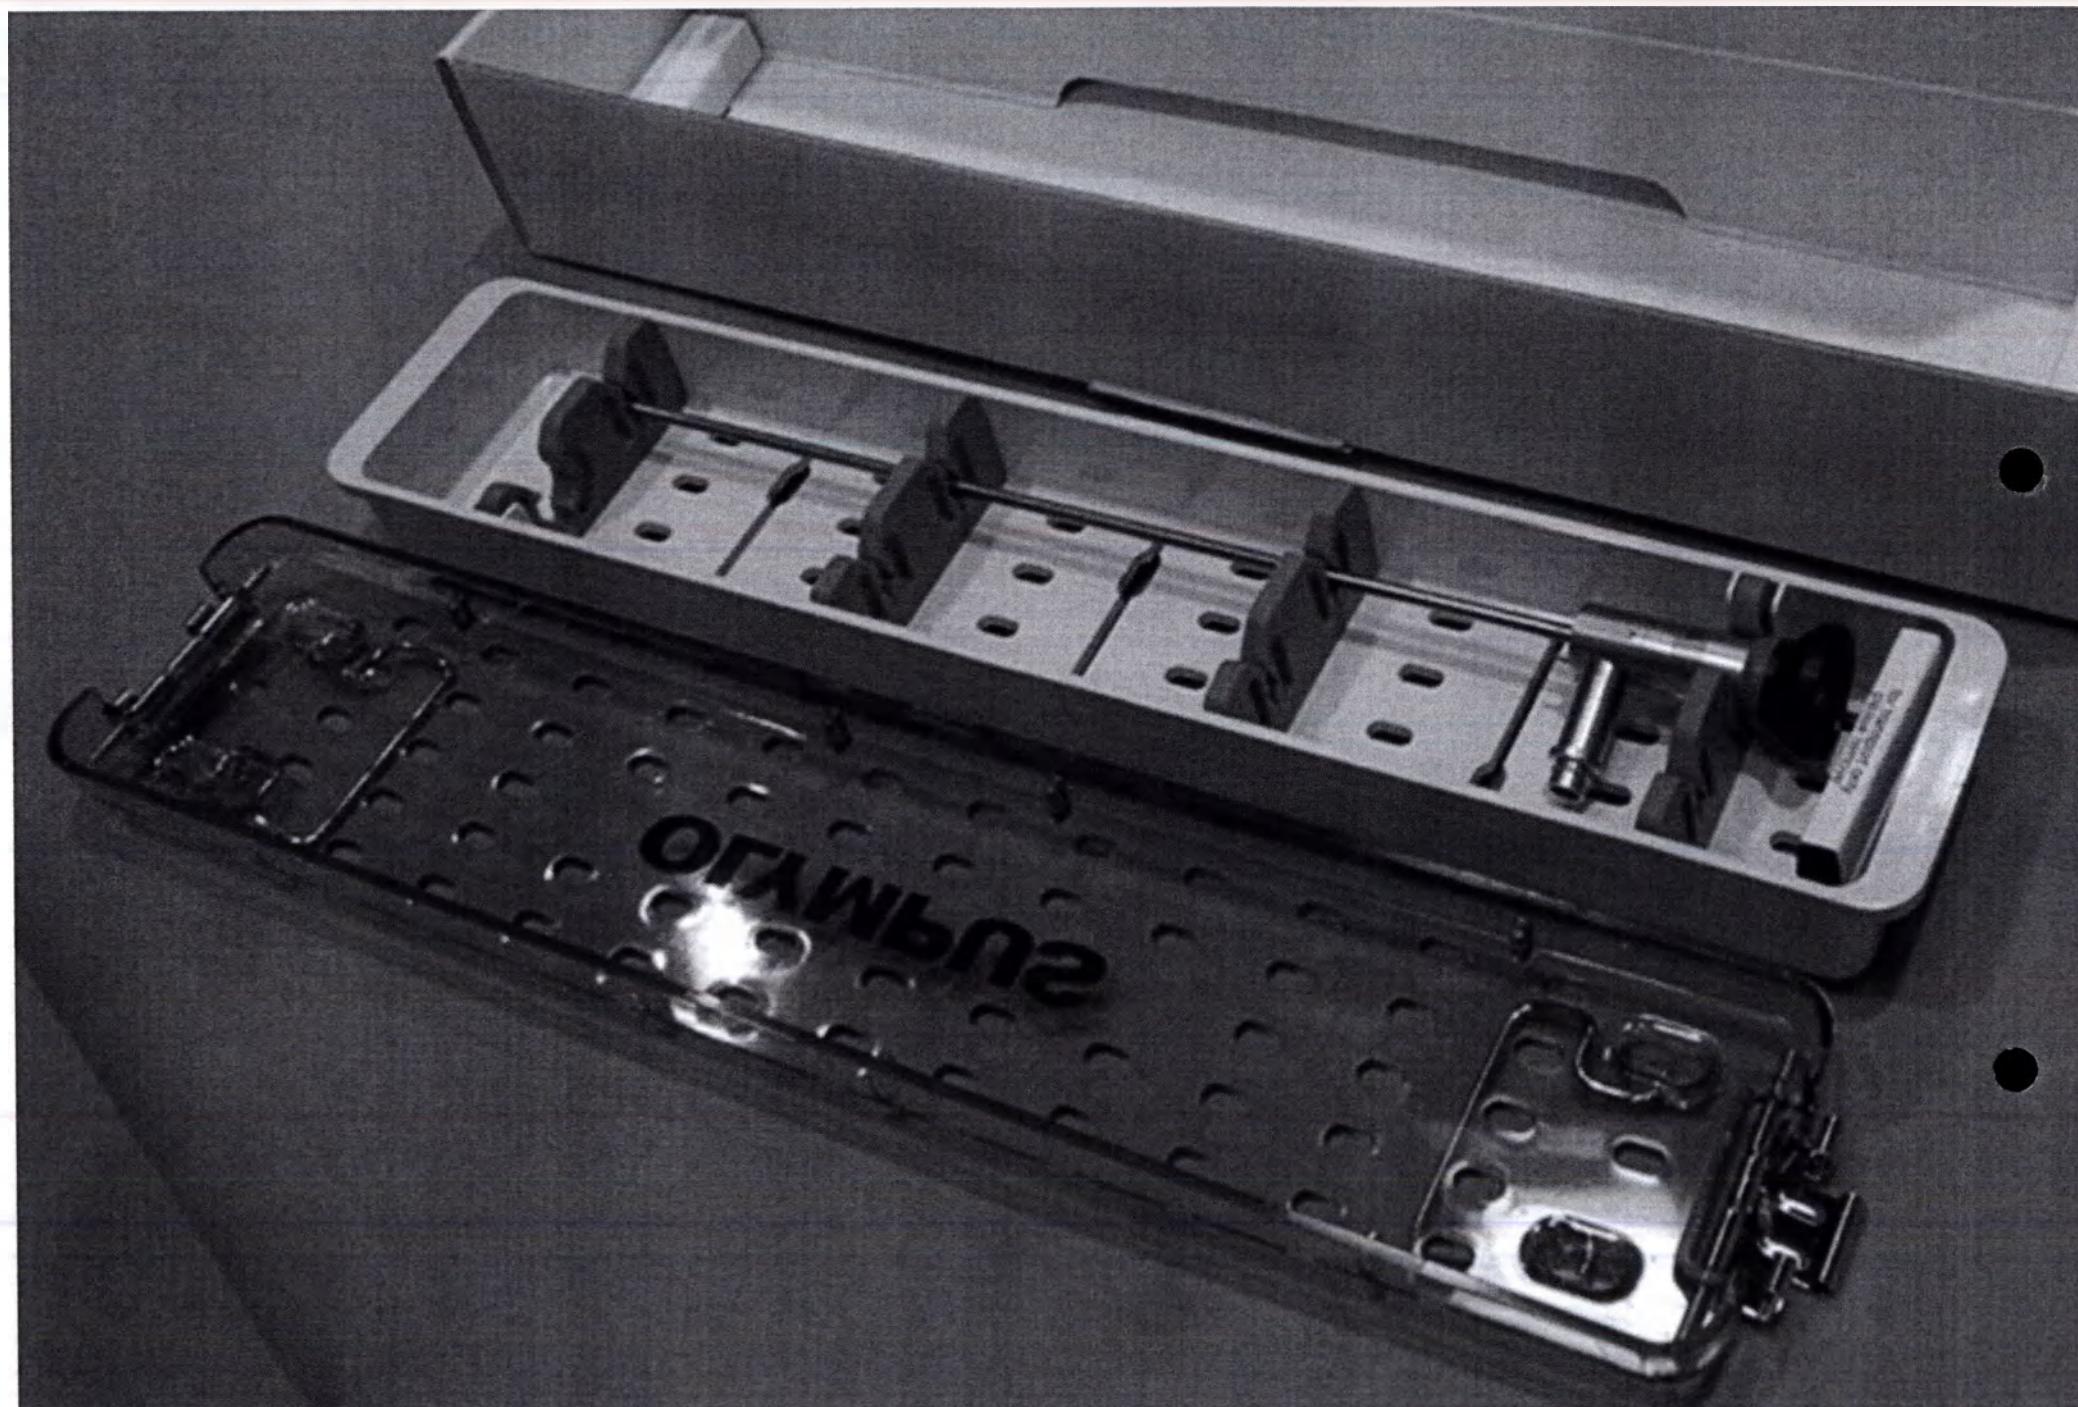

Контейнер для телескопов: A05951A(макет маркировки)


Артикул	Контейнер для телескопов: A05951A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

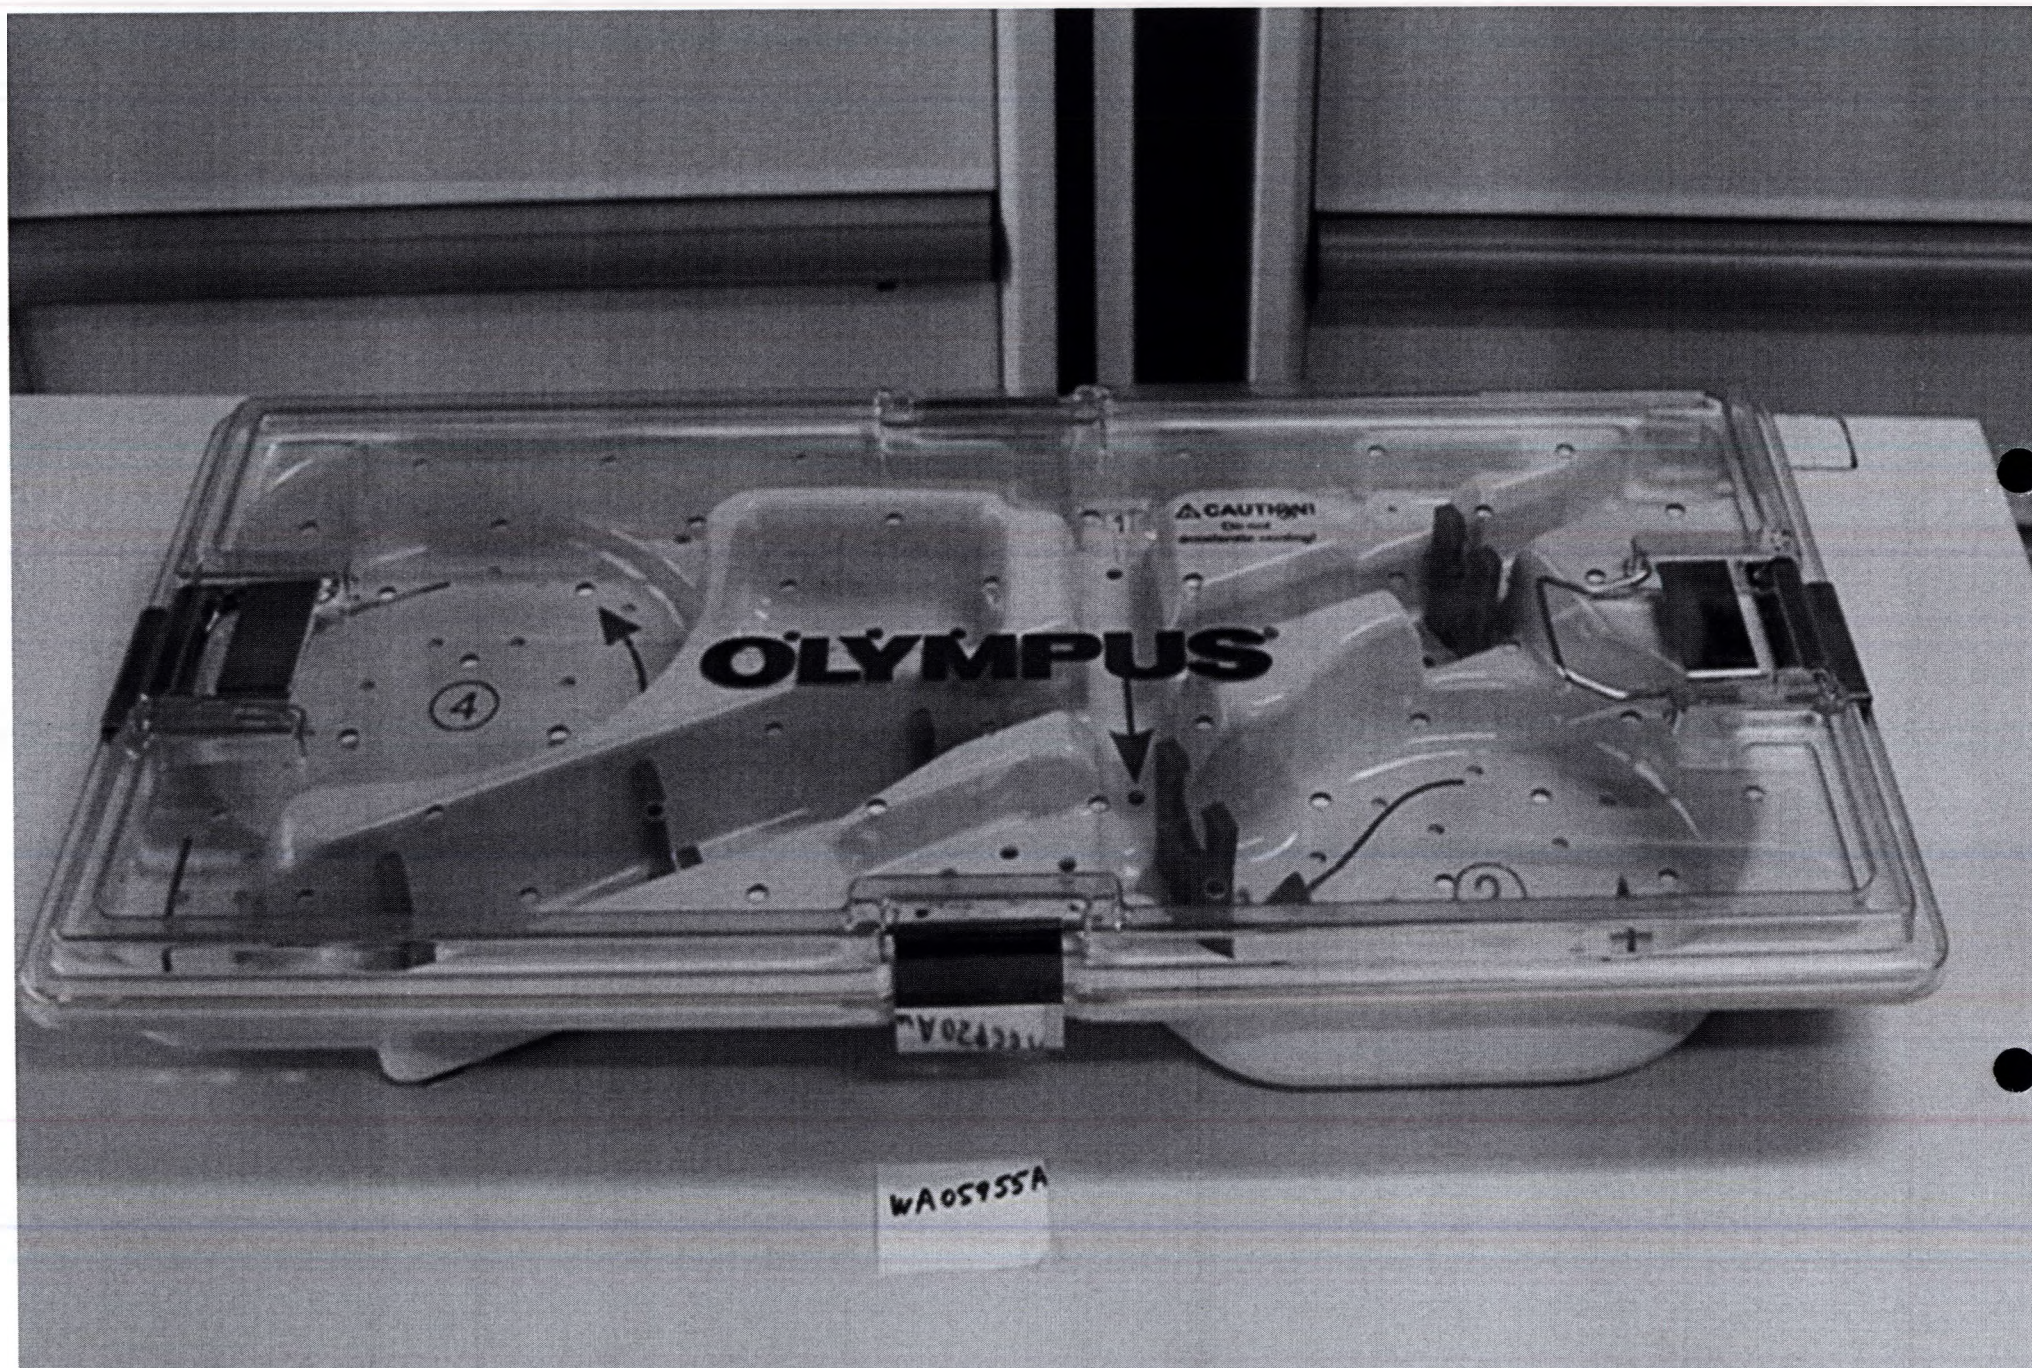

Поддон для инструментов: WA05954A, WA59383A, WA05991A, WA59381A, A05952A, A20910A, WA05995A, WA59380A, A5976, A5977, WA05955A,

Поддон для инструментов: WA05954A (макет маркировки)


Артикул	Поддон для инструментов: WA05954A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

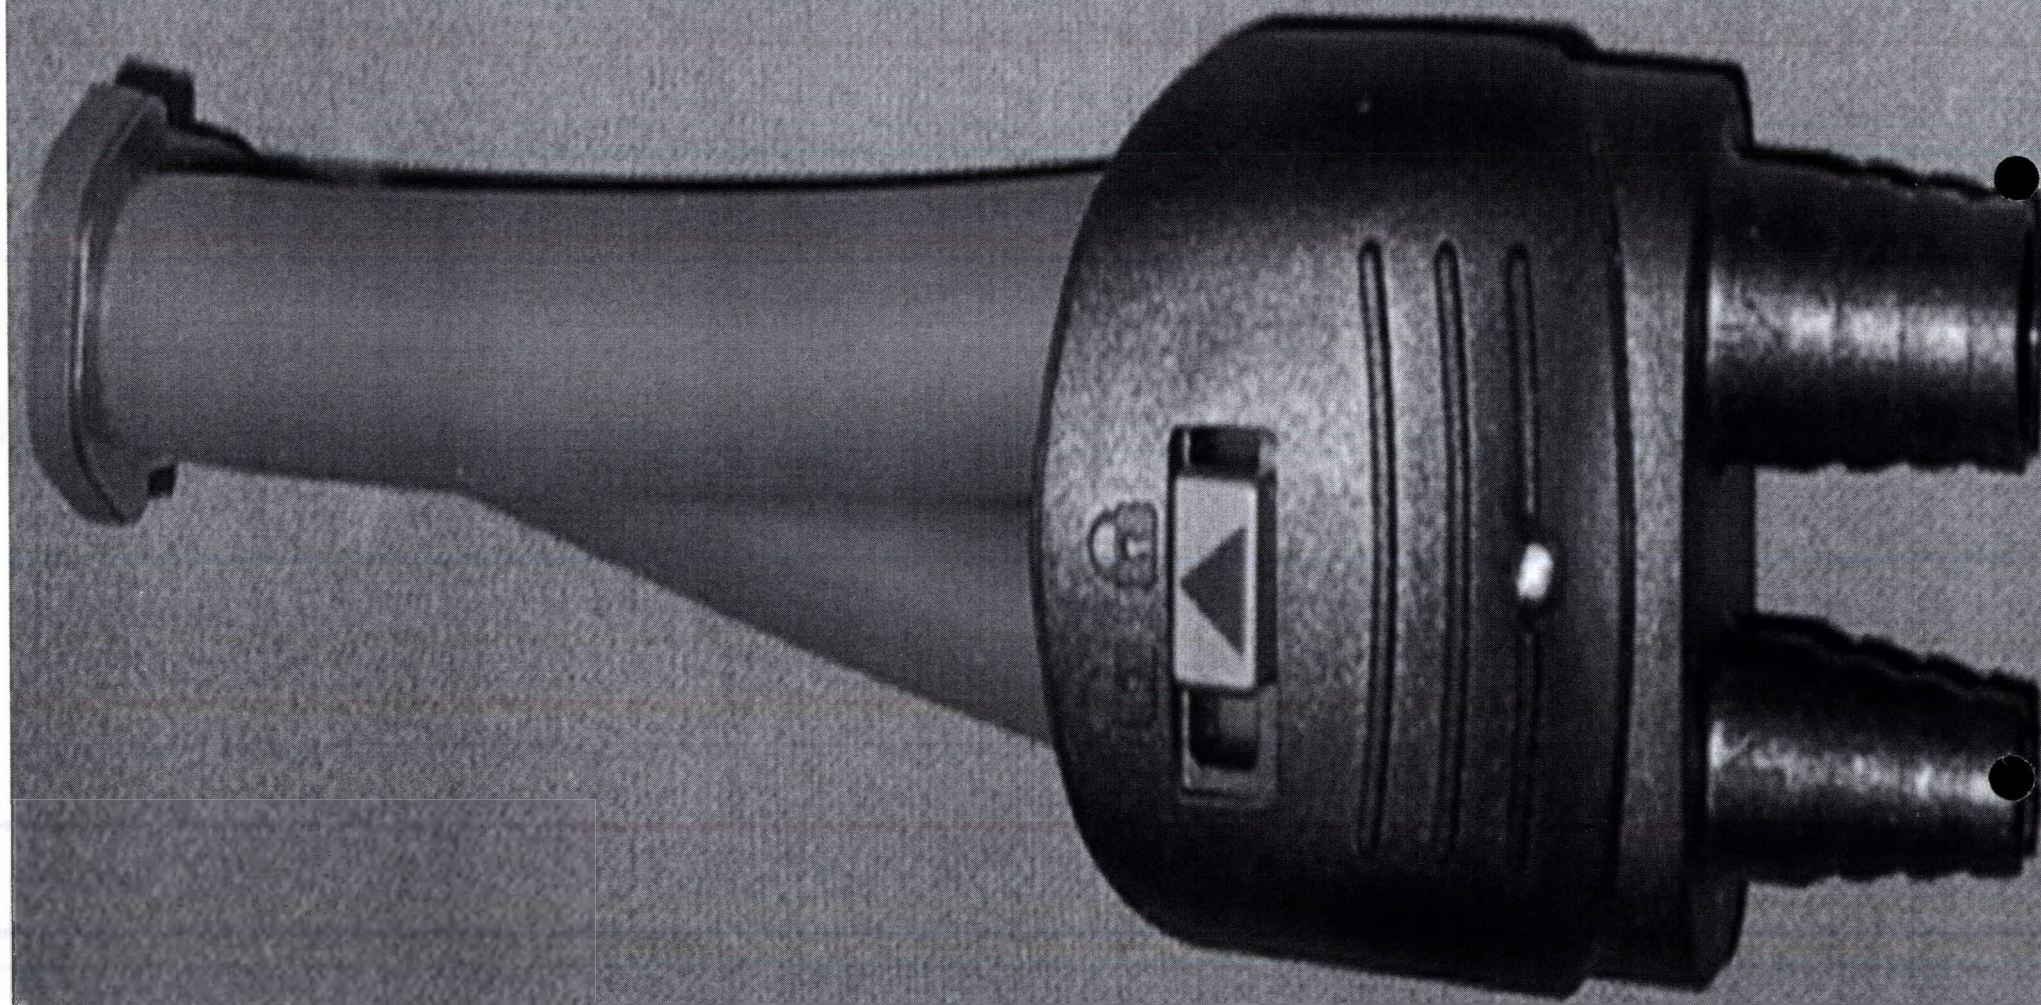

Клапан трубки: WA51181L, WA51181S, A4706, O0174, A4559, A5833, A5834, A5839.


Клапан трубки: WA51181L (макет маркировки)

Артикул	Клапан трубки: WA51181L
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

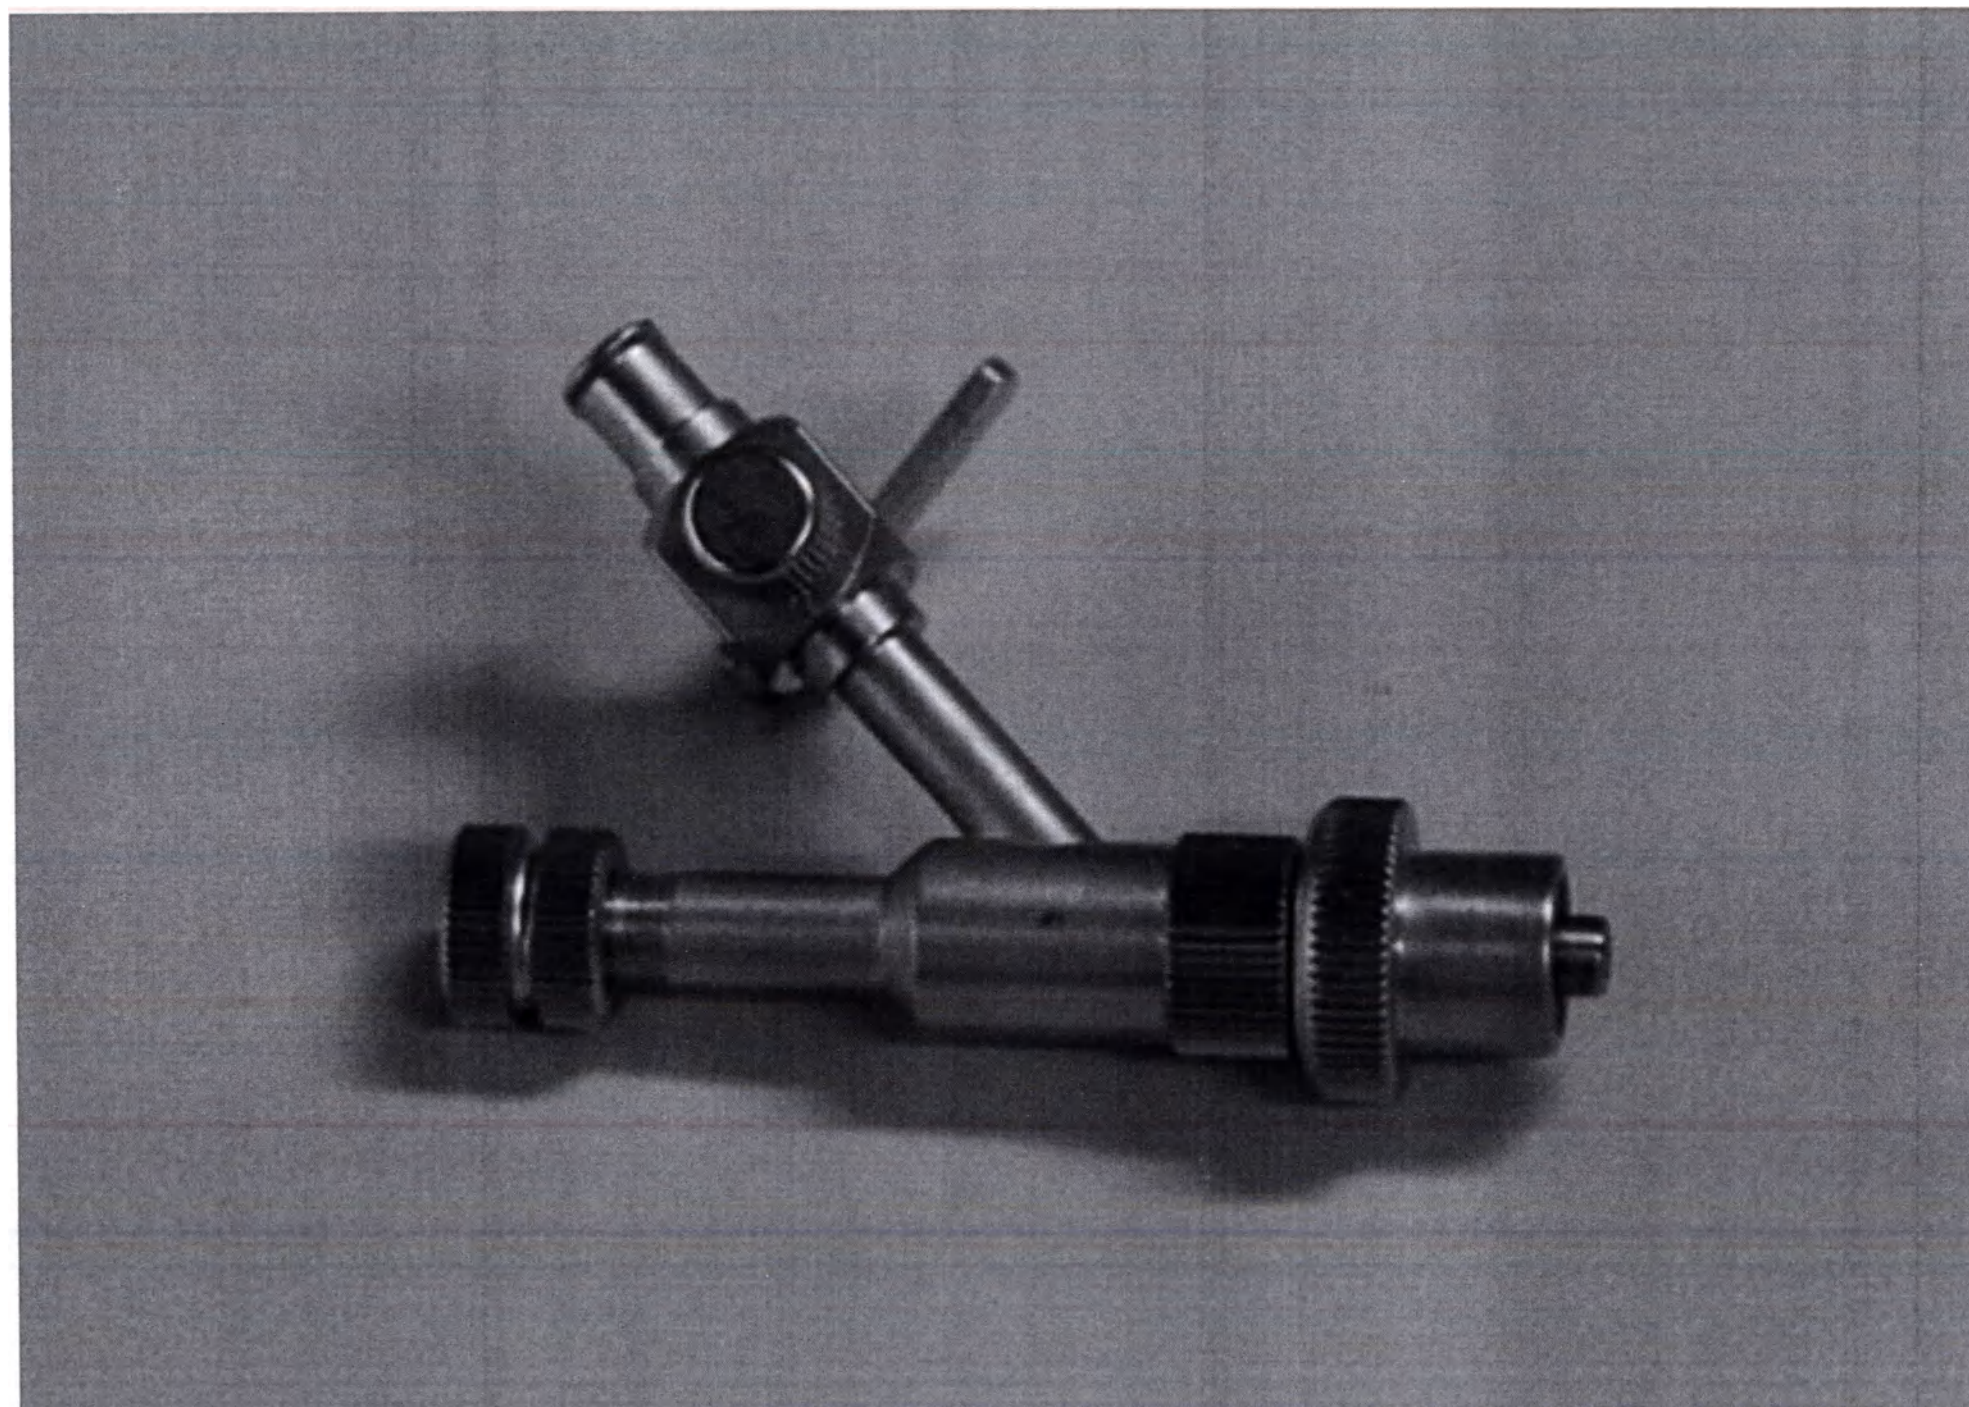


Кран запорный: 00102.1 (макет маркировки)

Артикул	Кран запорный: 00102.1
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

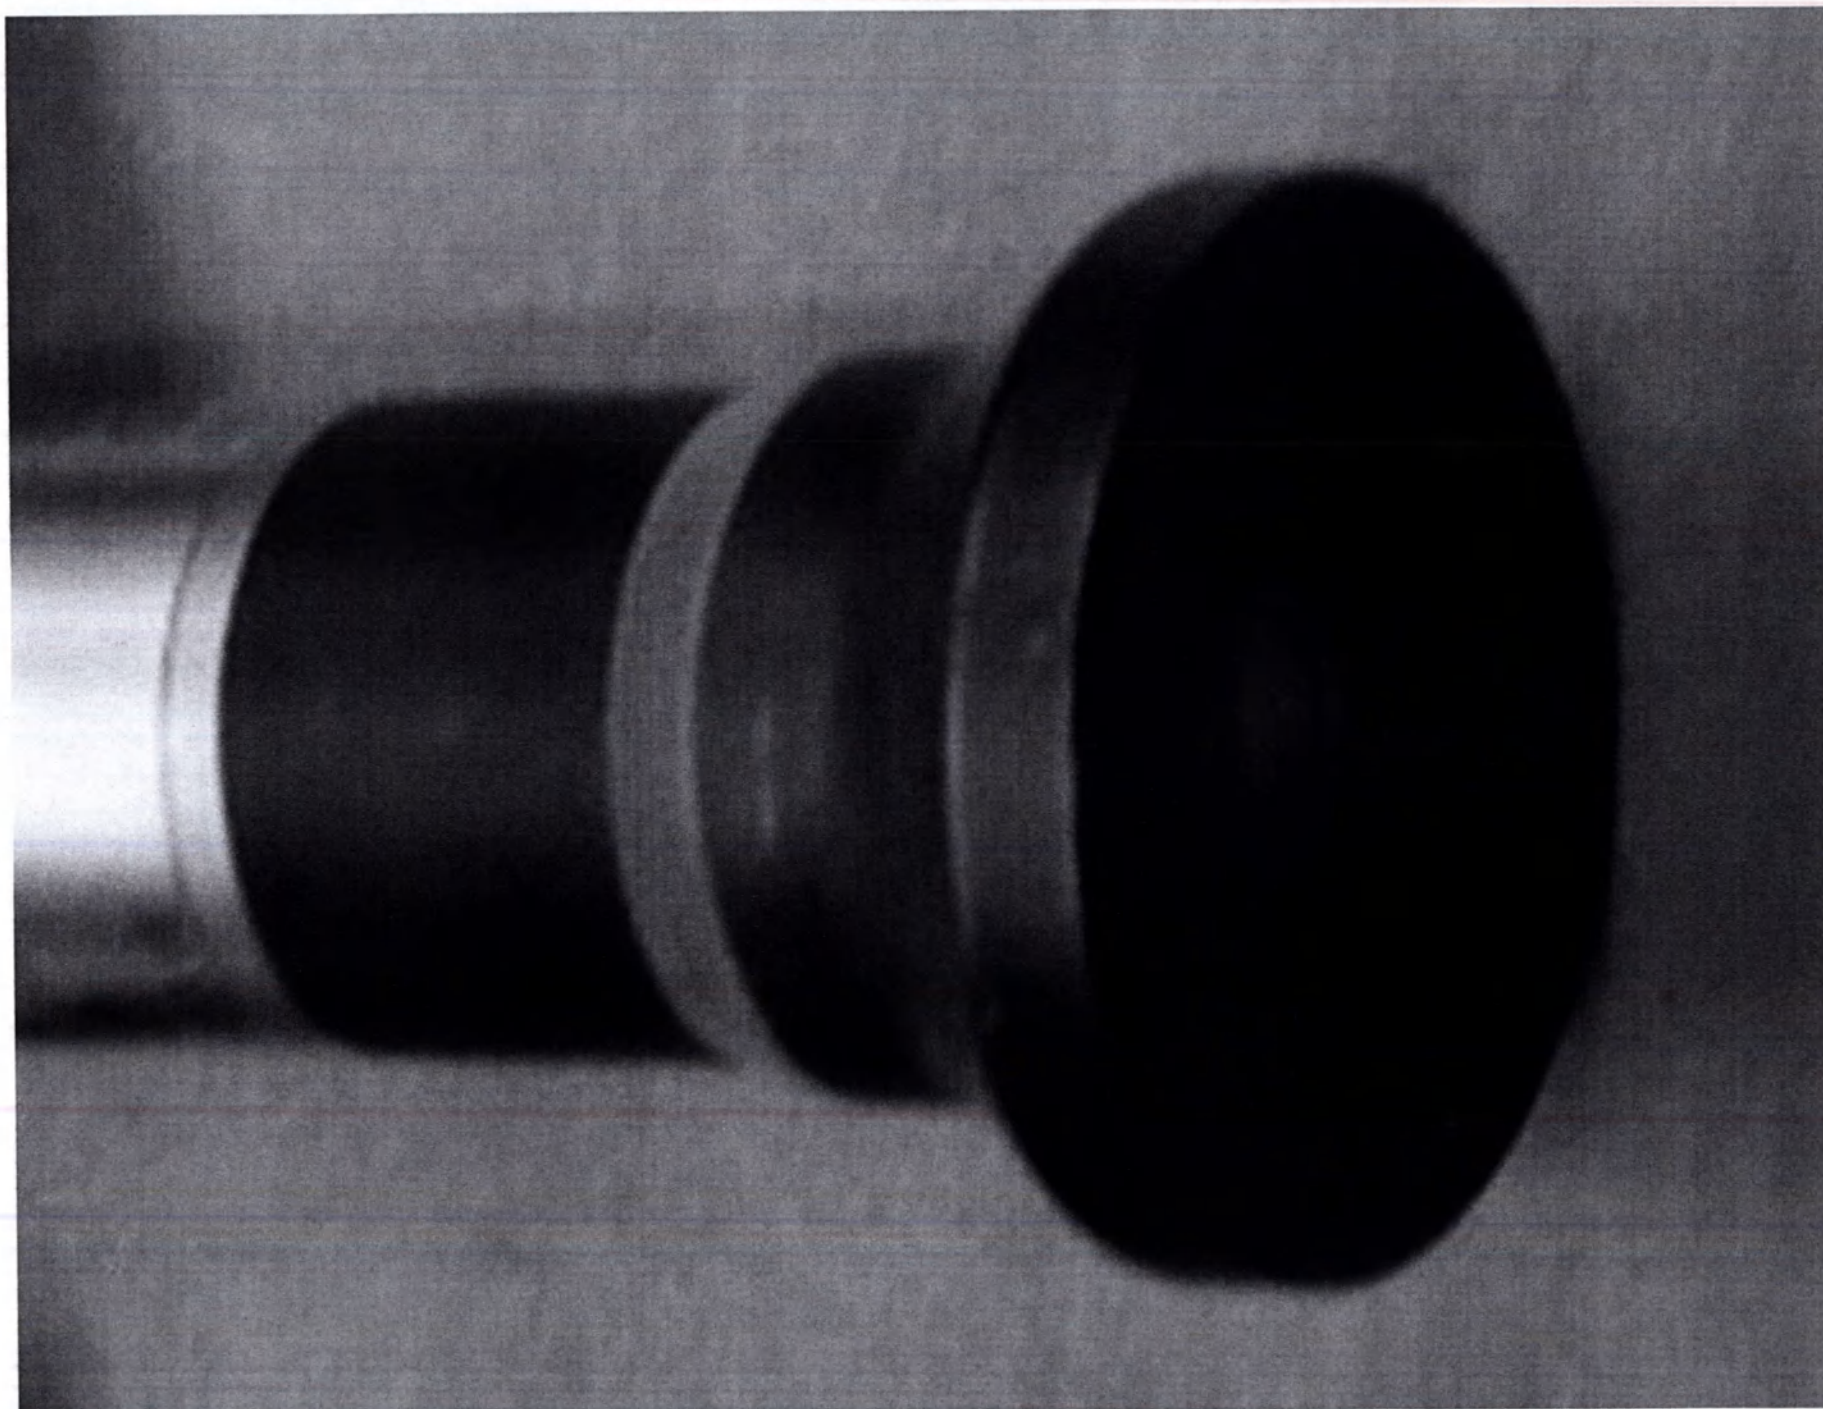

Крышка окуляра: A5260 (макет маркировки)

Артикул	Крышка окуляра: A5260
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

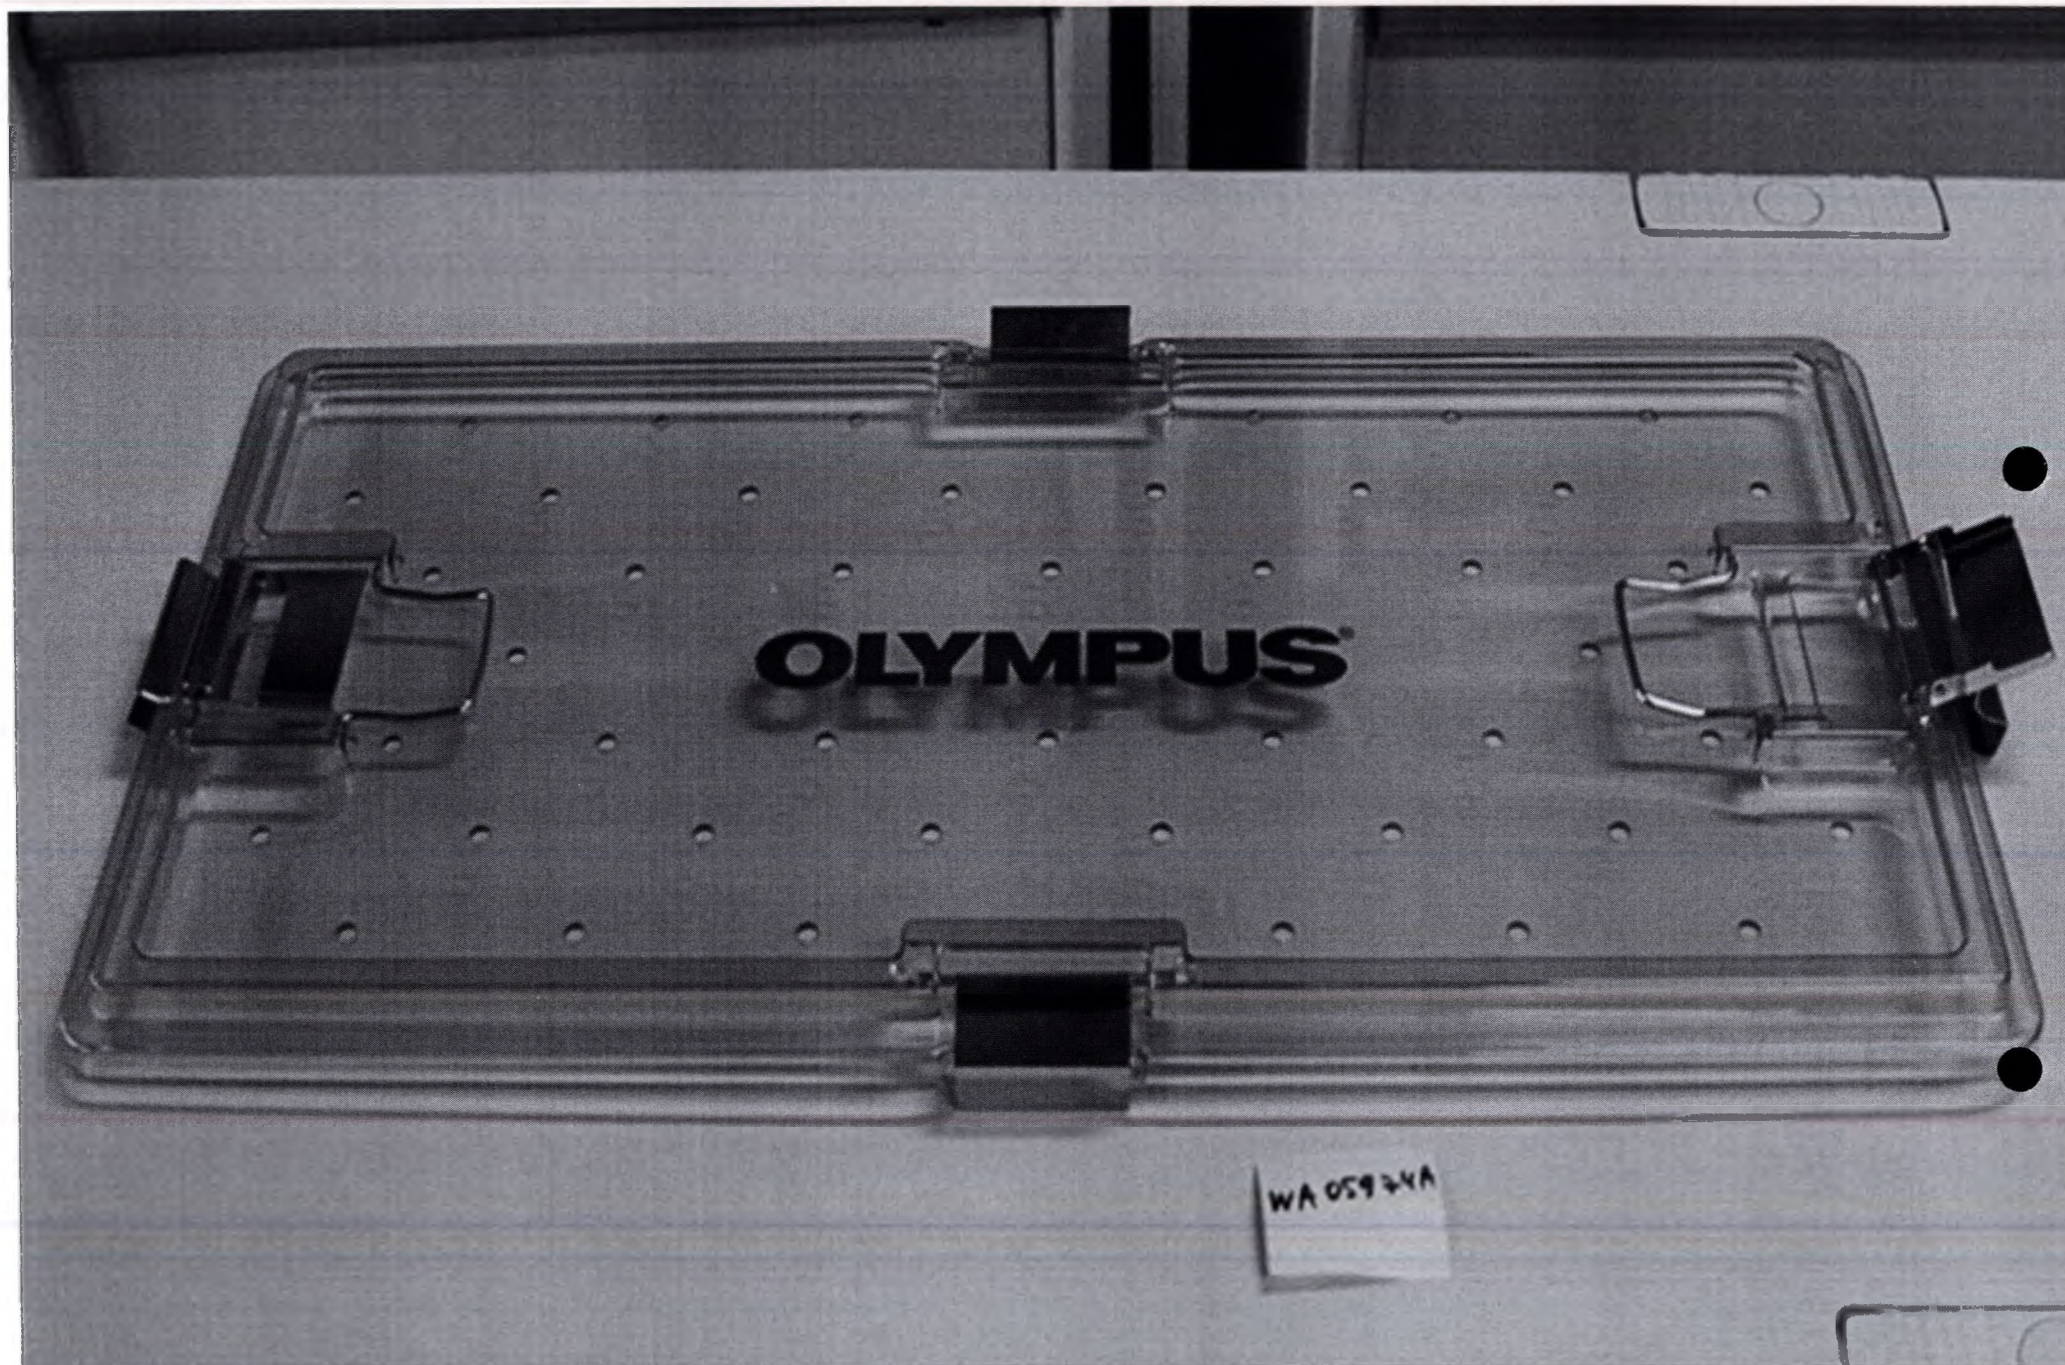

Оболочка: WA60800C, WA60801C, WA05974A.

Оболочка: WA60800C (макет маркировки)

Артикул	Оболочка: WA60800C
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Покровное стекло: 03653.

Покровное стекло: О3653.(макет маркировки)

Артикул	Покровное стекло: О3653.
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации




A 22051 A

Порт ирригационный: WA00395A, WA00396A, A02908A, A22051A, A22052A, A22053A, A22054A, A22055A.


Порт ирригационный: WA00395A (макет маркировки)

Артикул	Порт ирригационный: WA00395A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

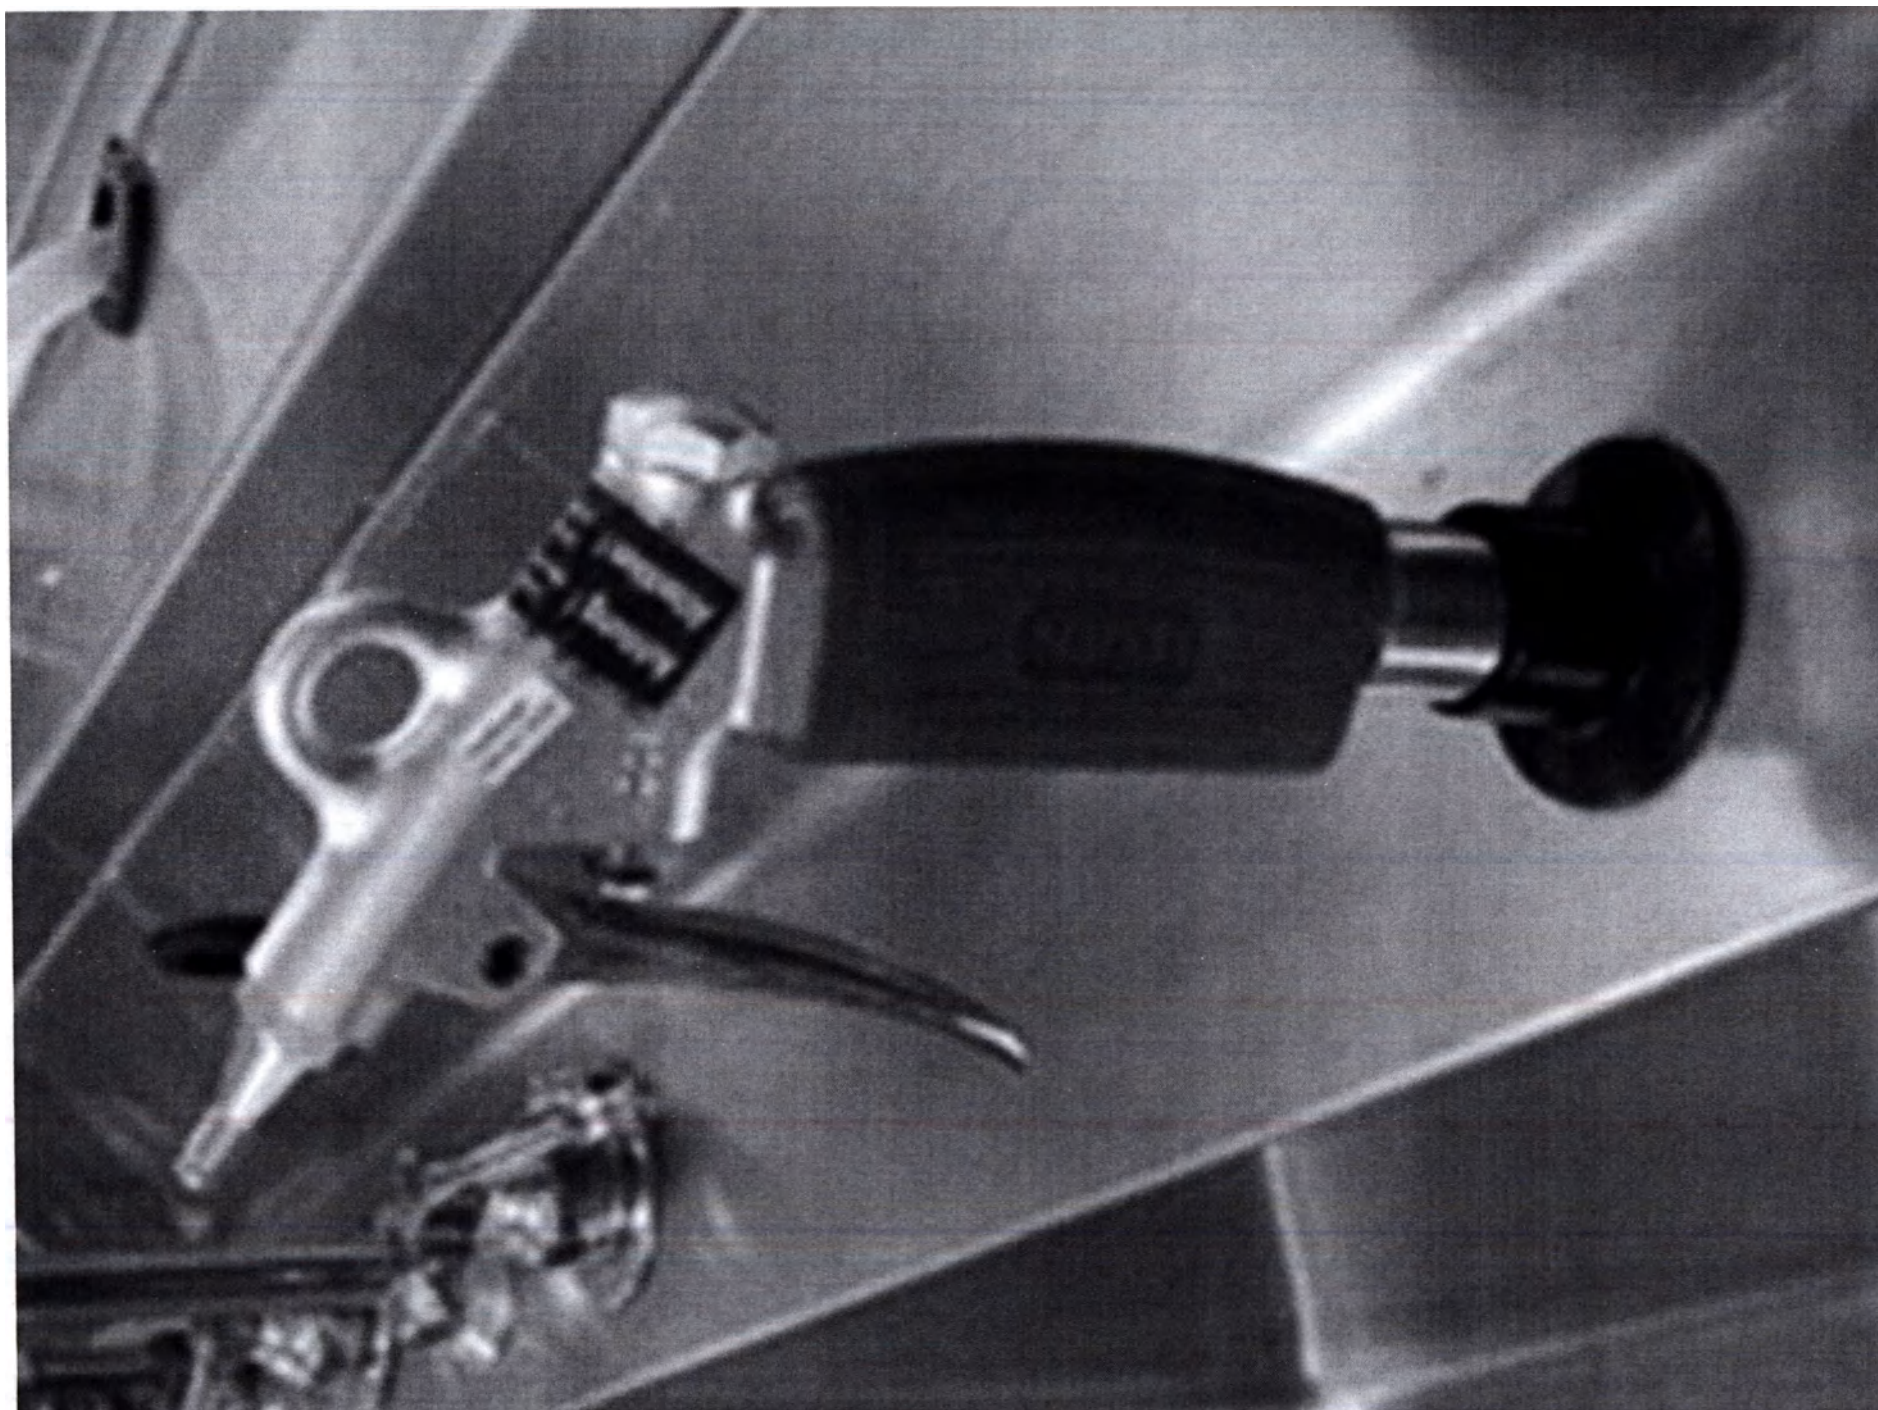

Приспособление для очистки: О0190.(макет маркировки)


Артикул	Приспособление для очистки: О0190
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

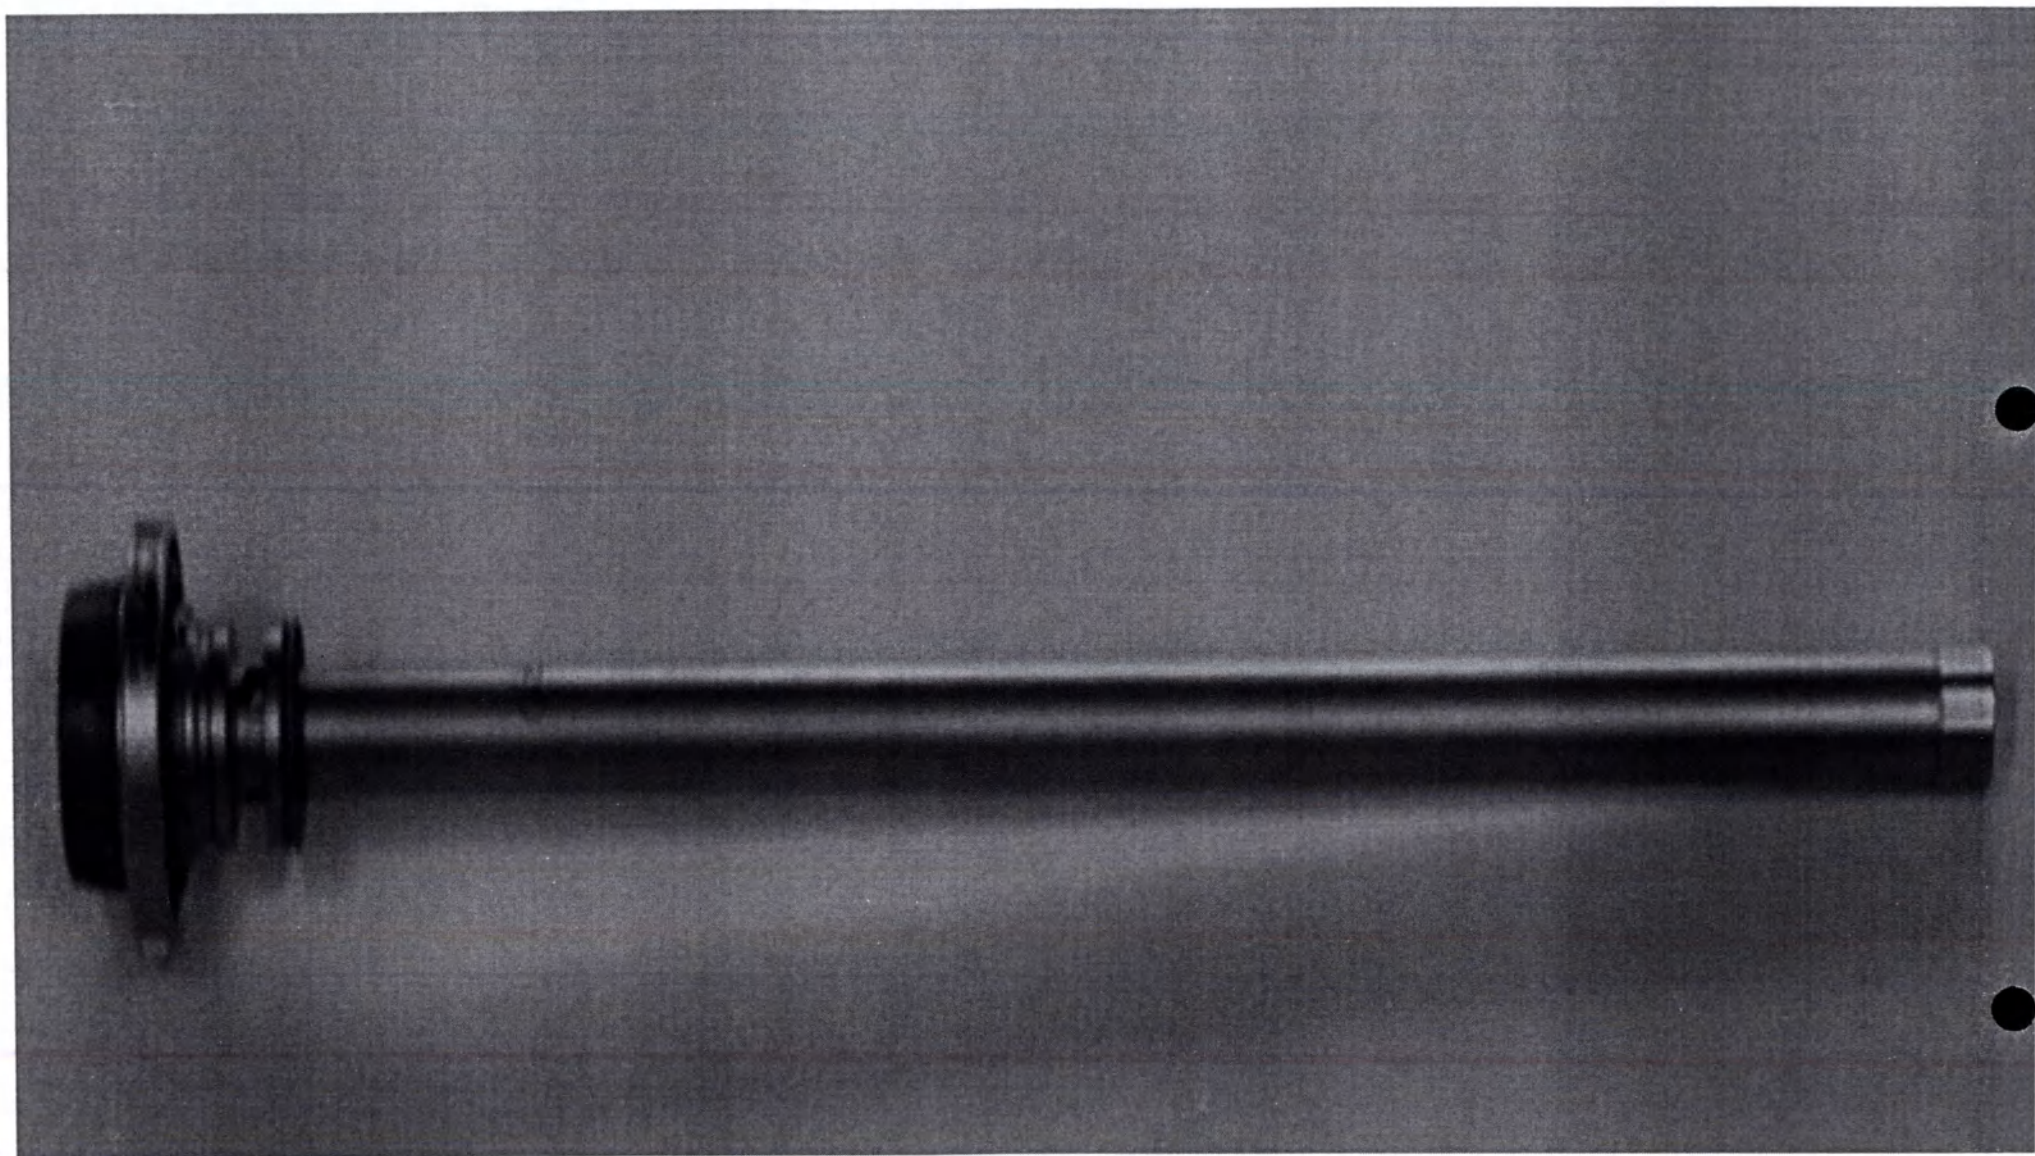

Проводник: WA37031A, WA33040A, WA33028A, A70958A.


Проводник: WA37031A (макет маркировки)

Артикул	Проводник: WA37031A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

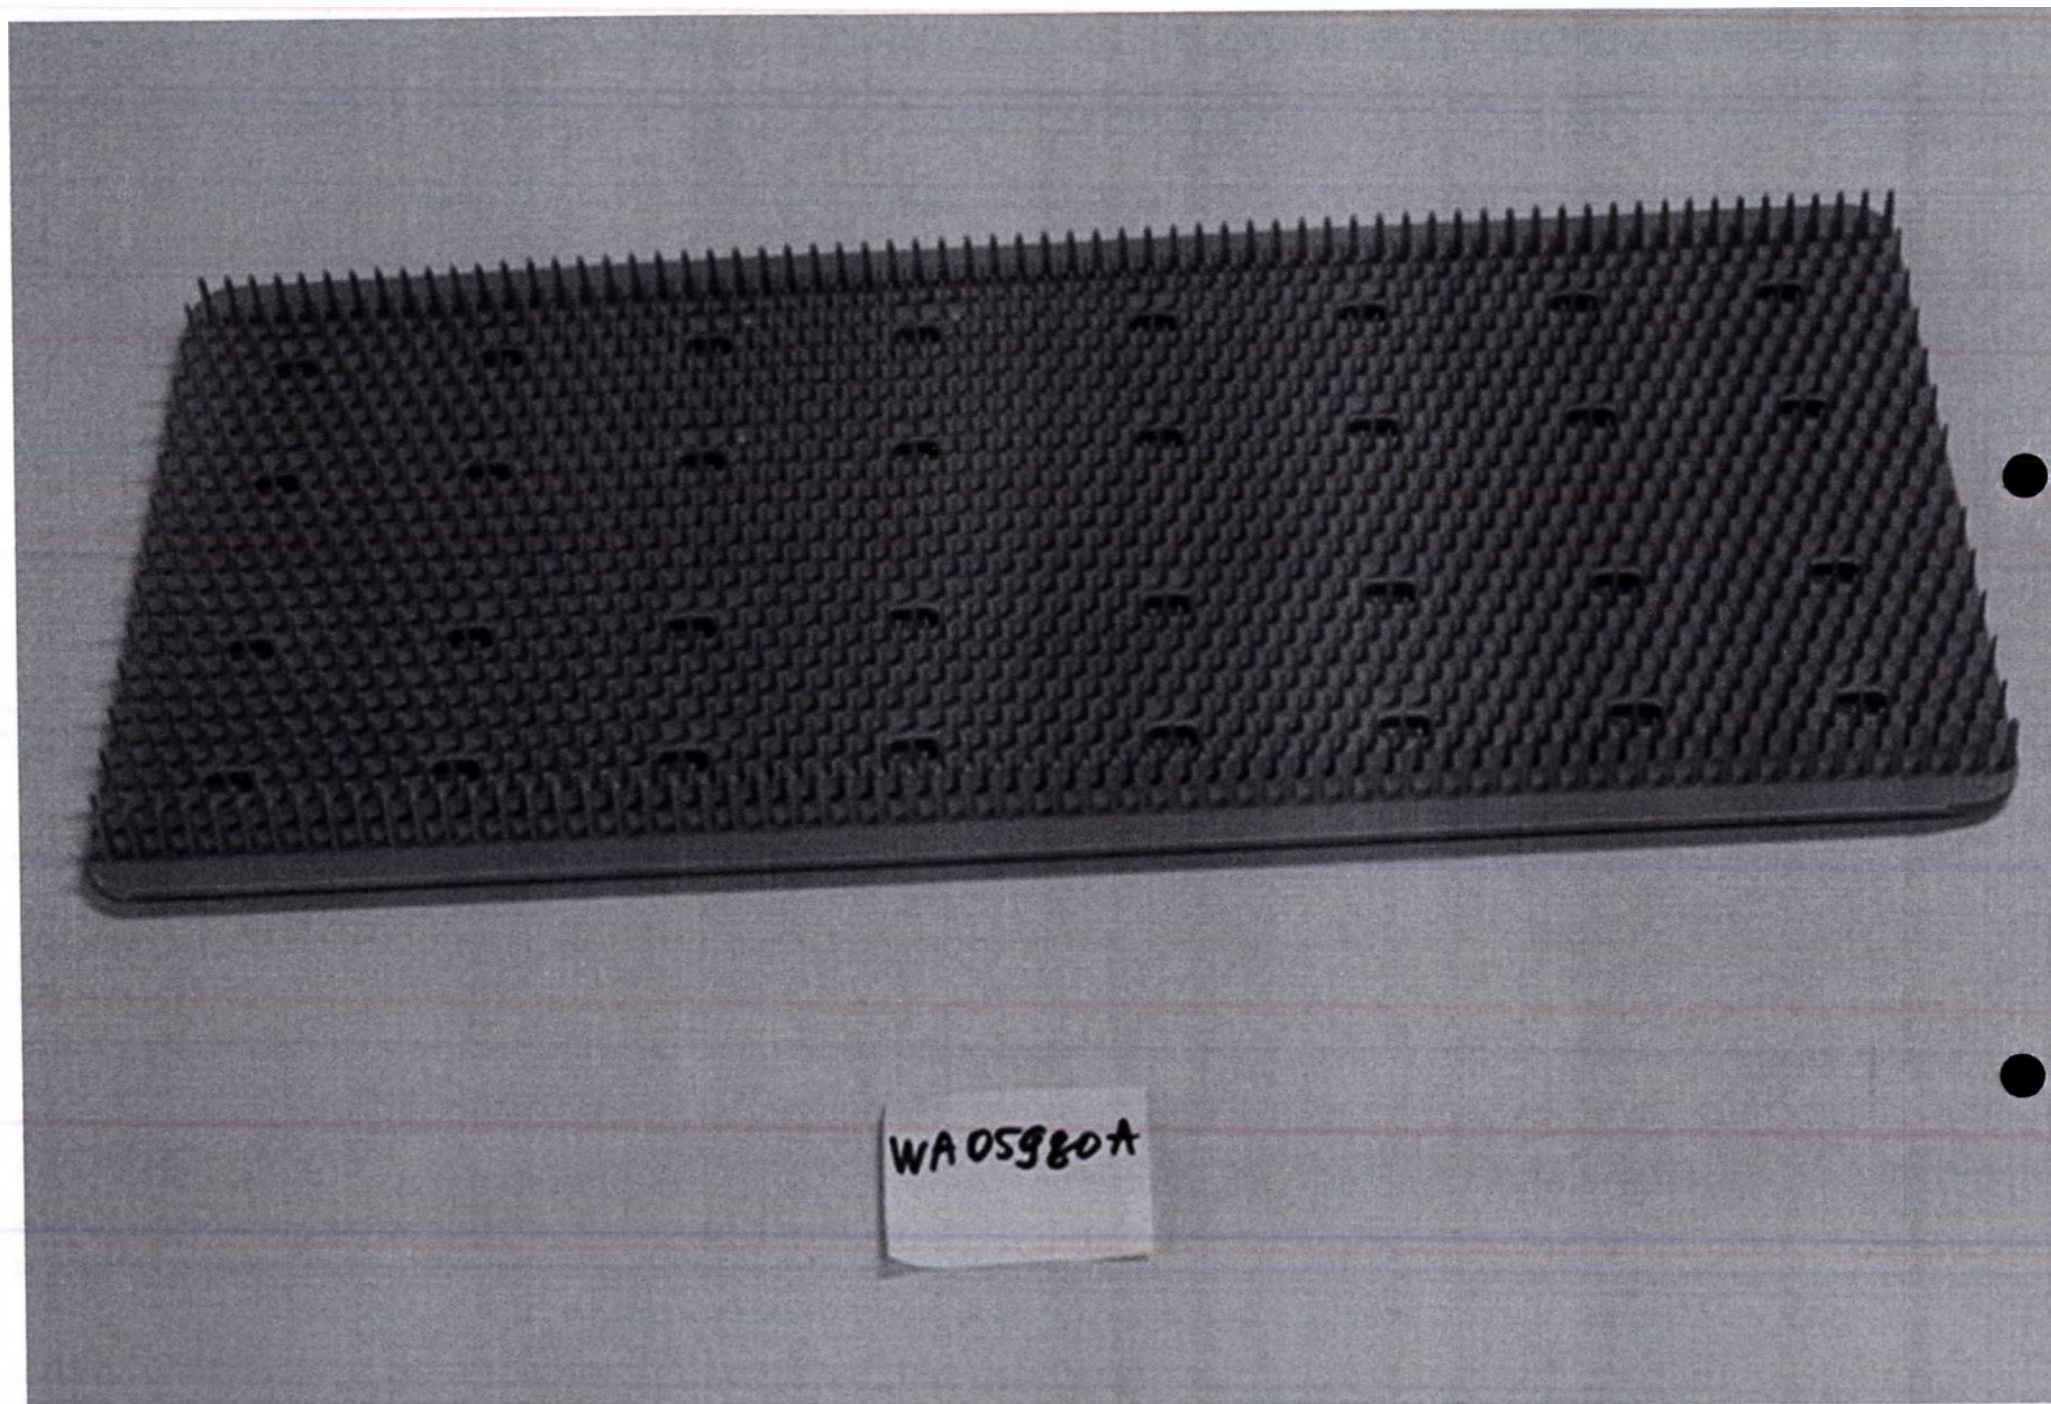


Прокладки резиновые: WA05980A (макет маркировки)

Артикул	Прокладки резиновые: WA05980A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

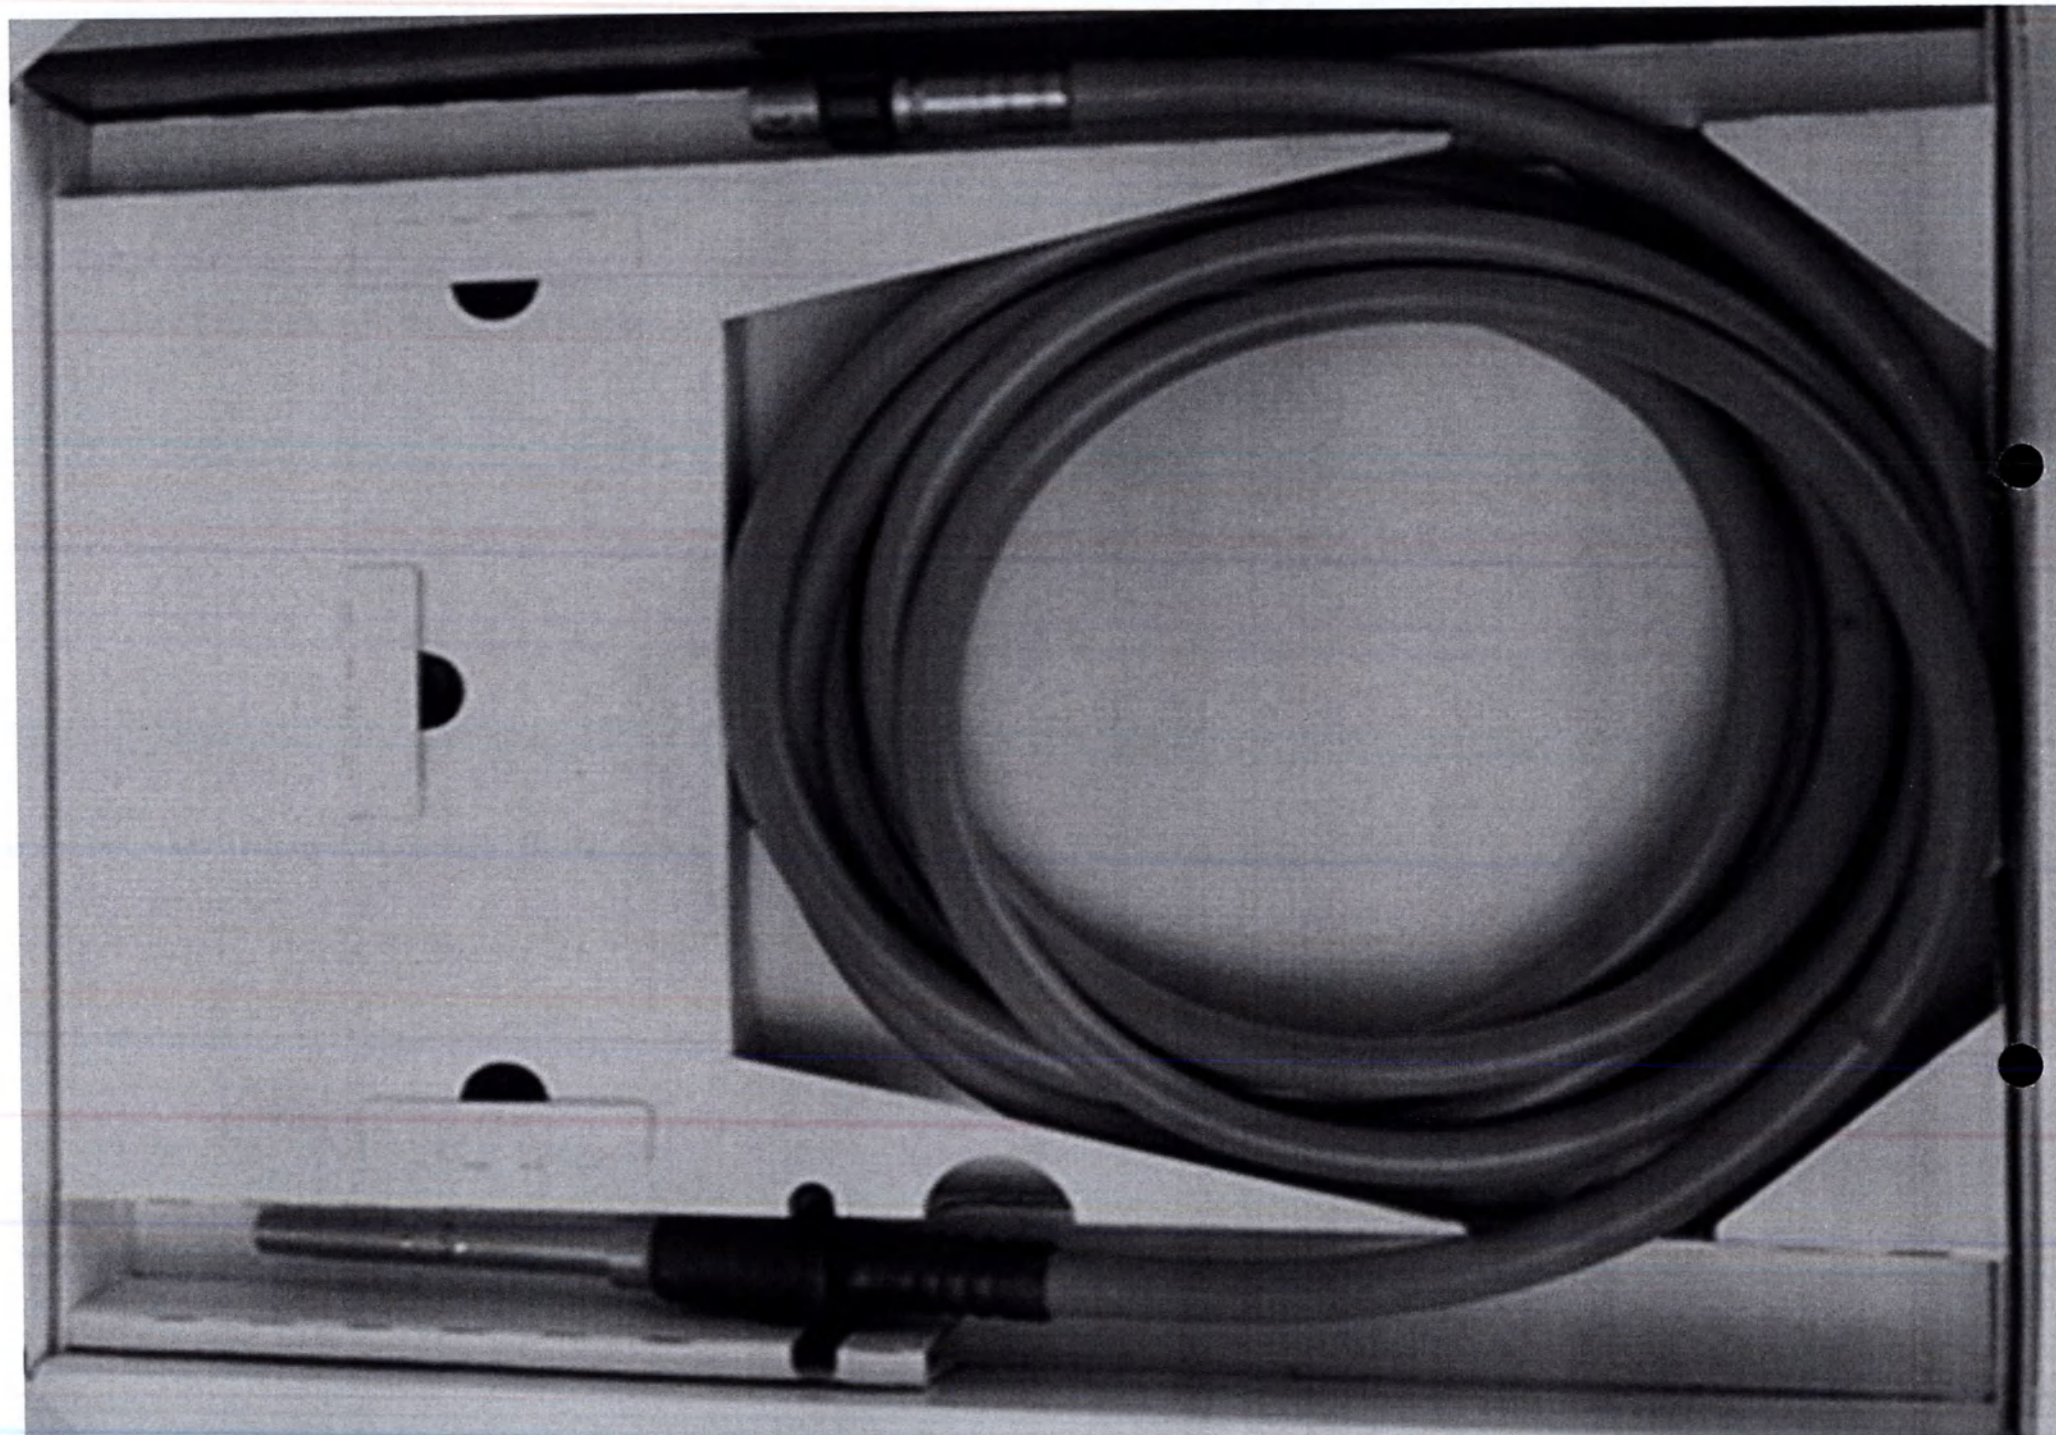

Световод: WA03200A (макет маркировки)

Артикул	Световод: WA03200A
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

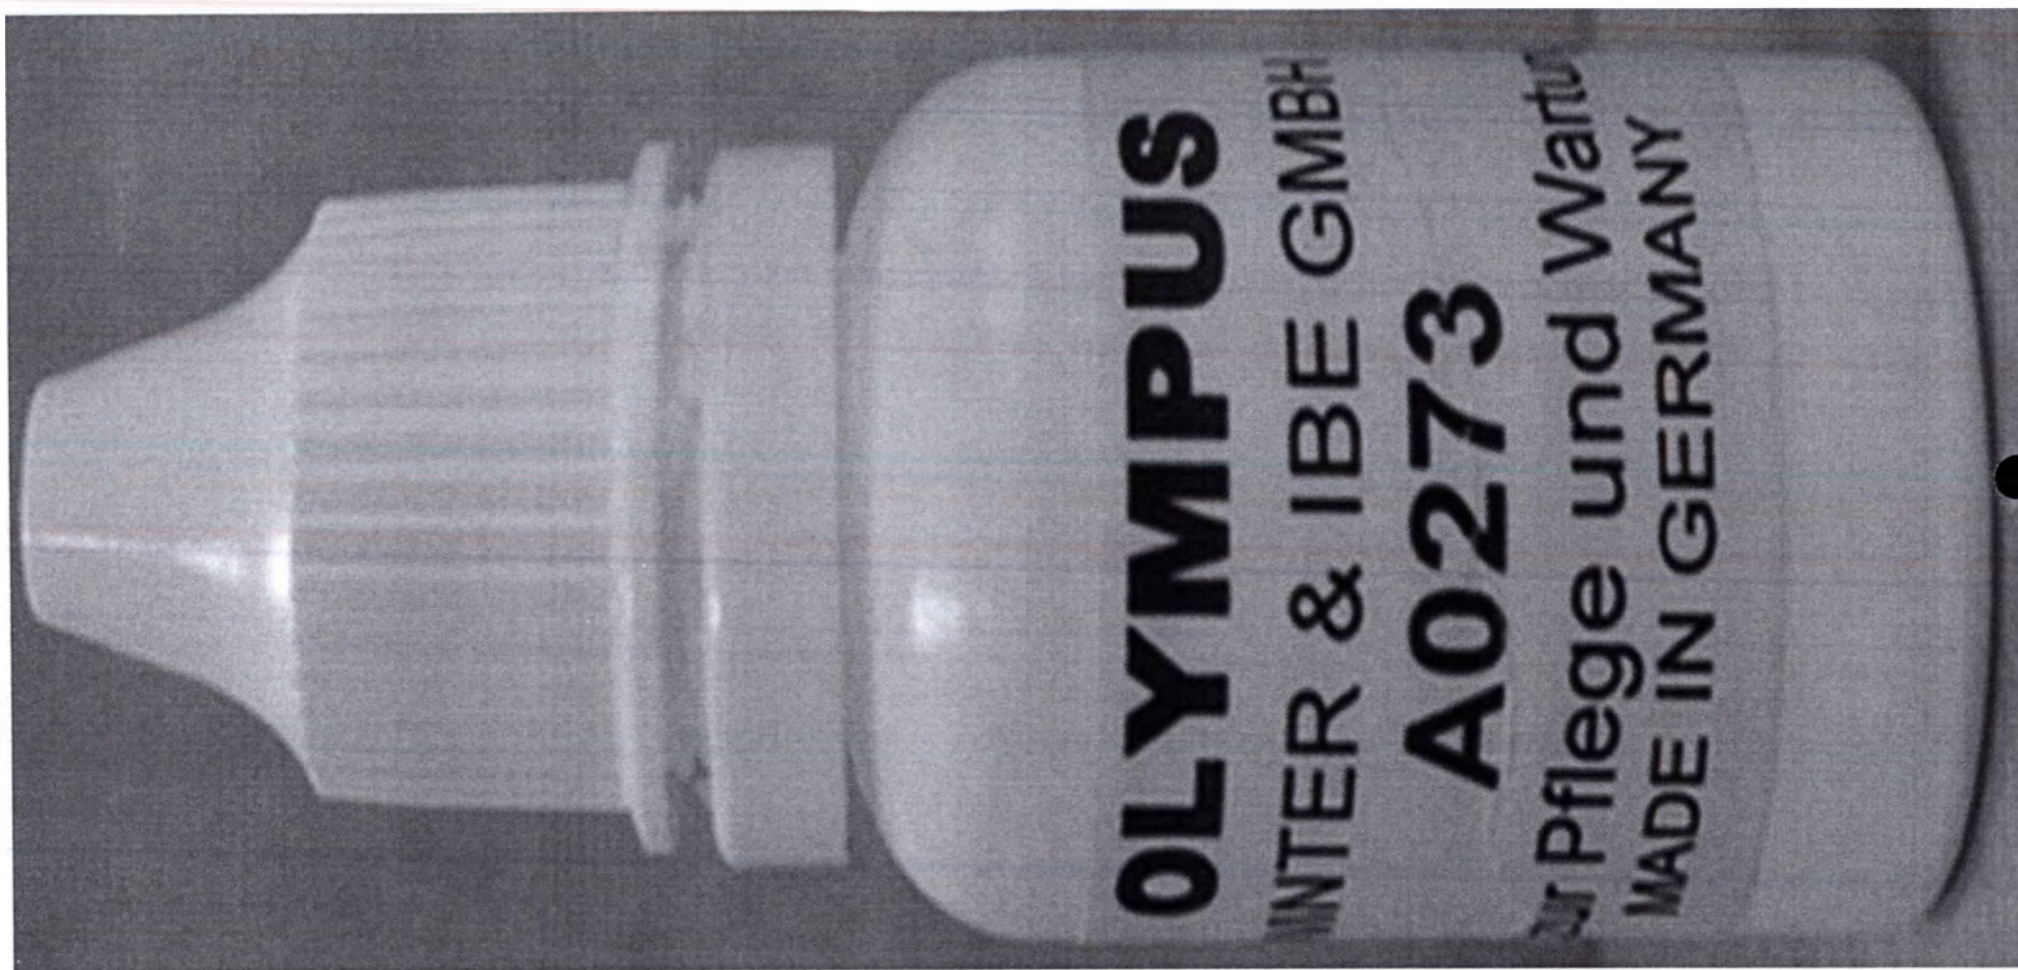

Средства смазочные специальные для обслуживания и ухода: A0273.

Средства смазочные специальные для обслуживания и ухода: A0273.(макет маркировки)


Артикул	Средства смазочные специальные для обслуживания и ухода: A0273
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Стержень для очистки оболочки: А0440.

Стержень для очистки оболочки: A0440.(макет маркировки)

Артикул	Стержень для очистки оболочки: A0440
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Йбе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

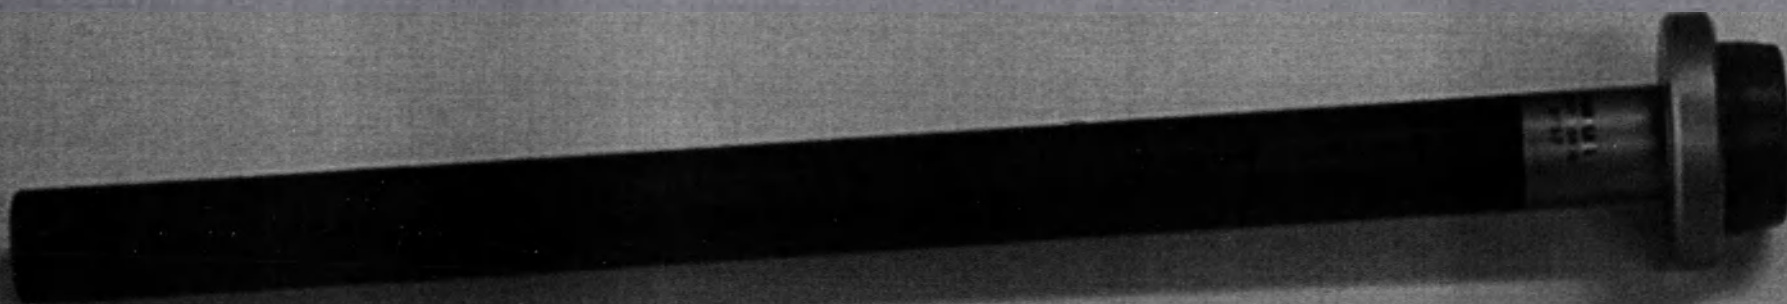


A 5838

Трубки: A5628 (10 шт.), WA58901A (10 шт.), A4056 (5 шт.), A02959A, A5610, O3664, A2250, A5837, A5838.

Трубки: А5628 (10 шт.) (макет маркировки)

Артикул	Трубки: А5628 (10 шт.)
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

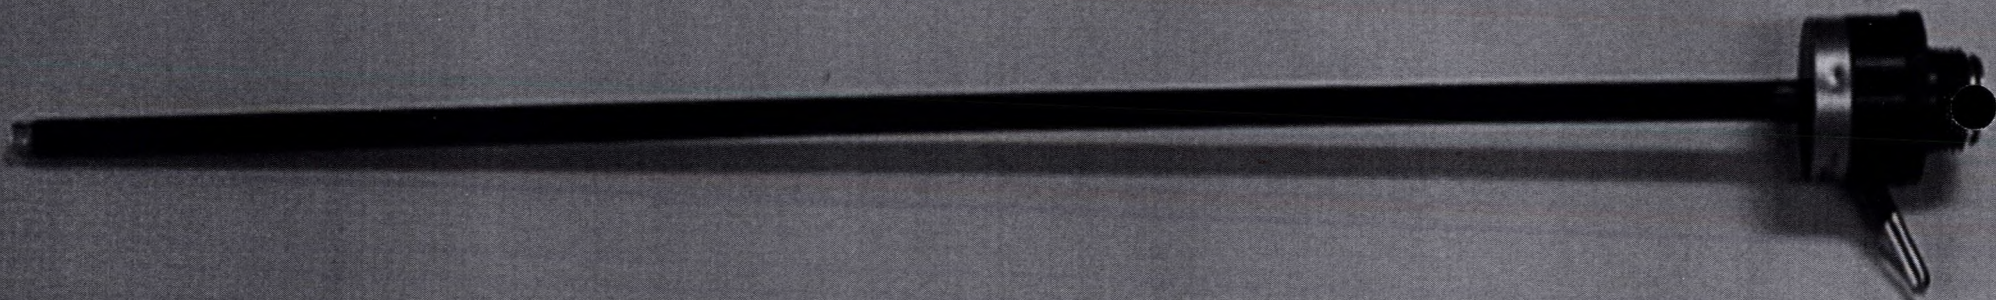

A 5653

Трубка отсоса/иригации: A5663, A5653, WA51111A, WA51131A, WA51131L, WA51132A, WA51138A, WA51151A, WA51151L, WA51152A, A2249.

Трубка отсоса/ирригации: А5663 (макет маркировки)

Артикул	Трубка отсоса/ирригации: А5663
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Трубки в наборах: O0314 (макет маркировки)

Артикул	Трубки в наборах: O0314
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Щетка для очистки: A0221, O0230, O0231, A0452, A0447, A0449, A0441, A0450, A0446, A0444, A0448, A0443, A0445, A0451.

Щетка для очистки: A0221 (макет маркировки)


Артикул	Щетка для очистки: A0221
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Эвакуатор: 03657.

Эвакуатор: O3657.(макет маркировки)


Артикул	Эвакуатор: O3657
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортёр	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

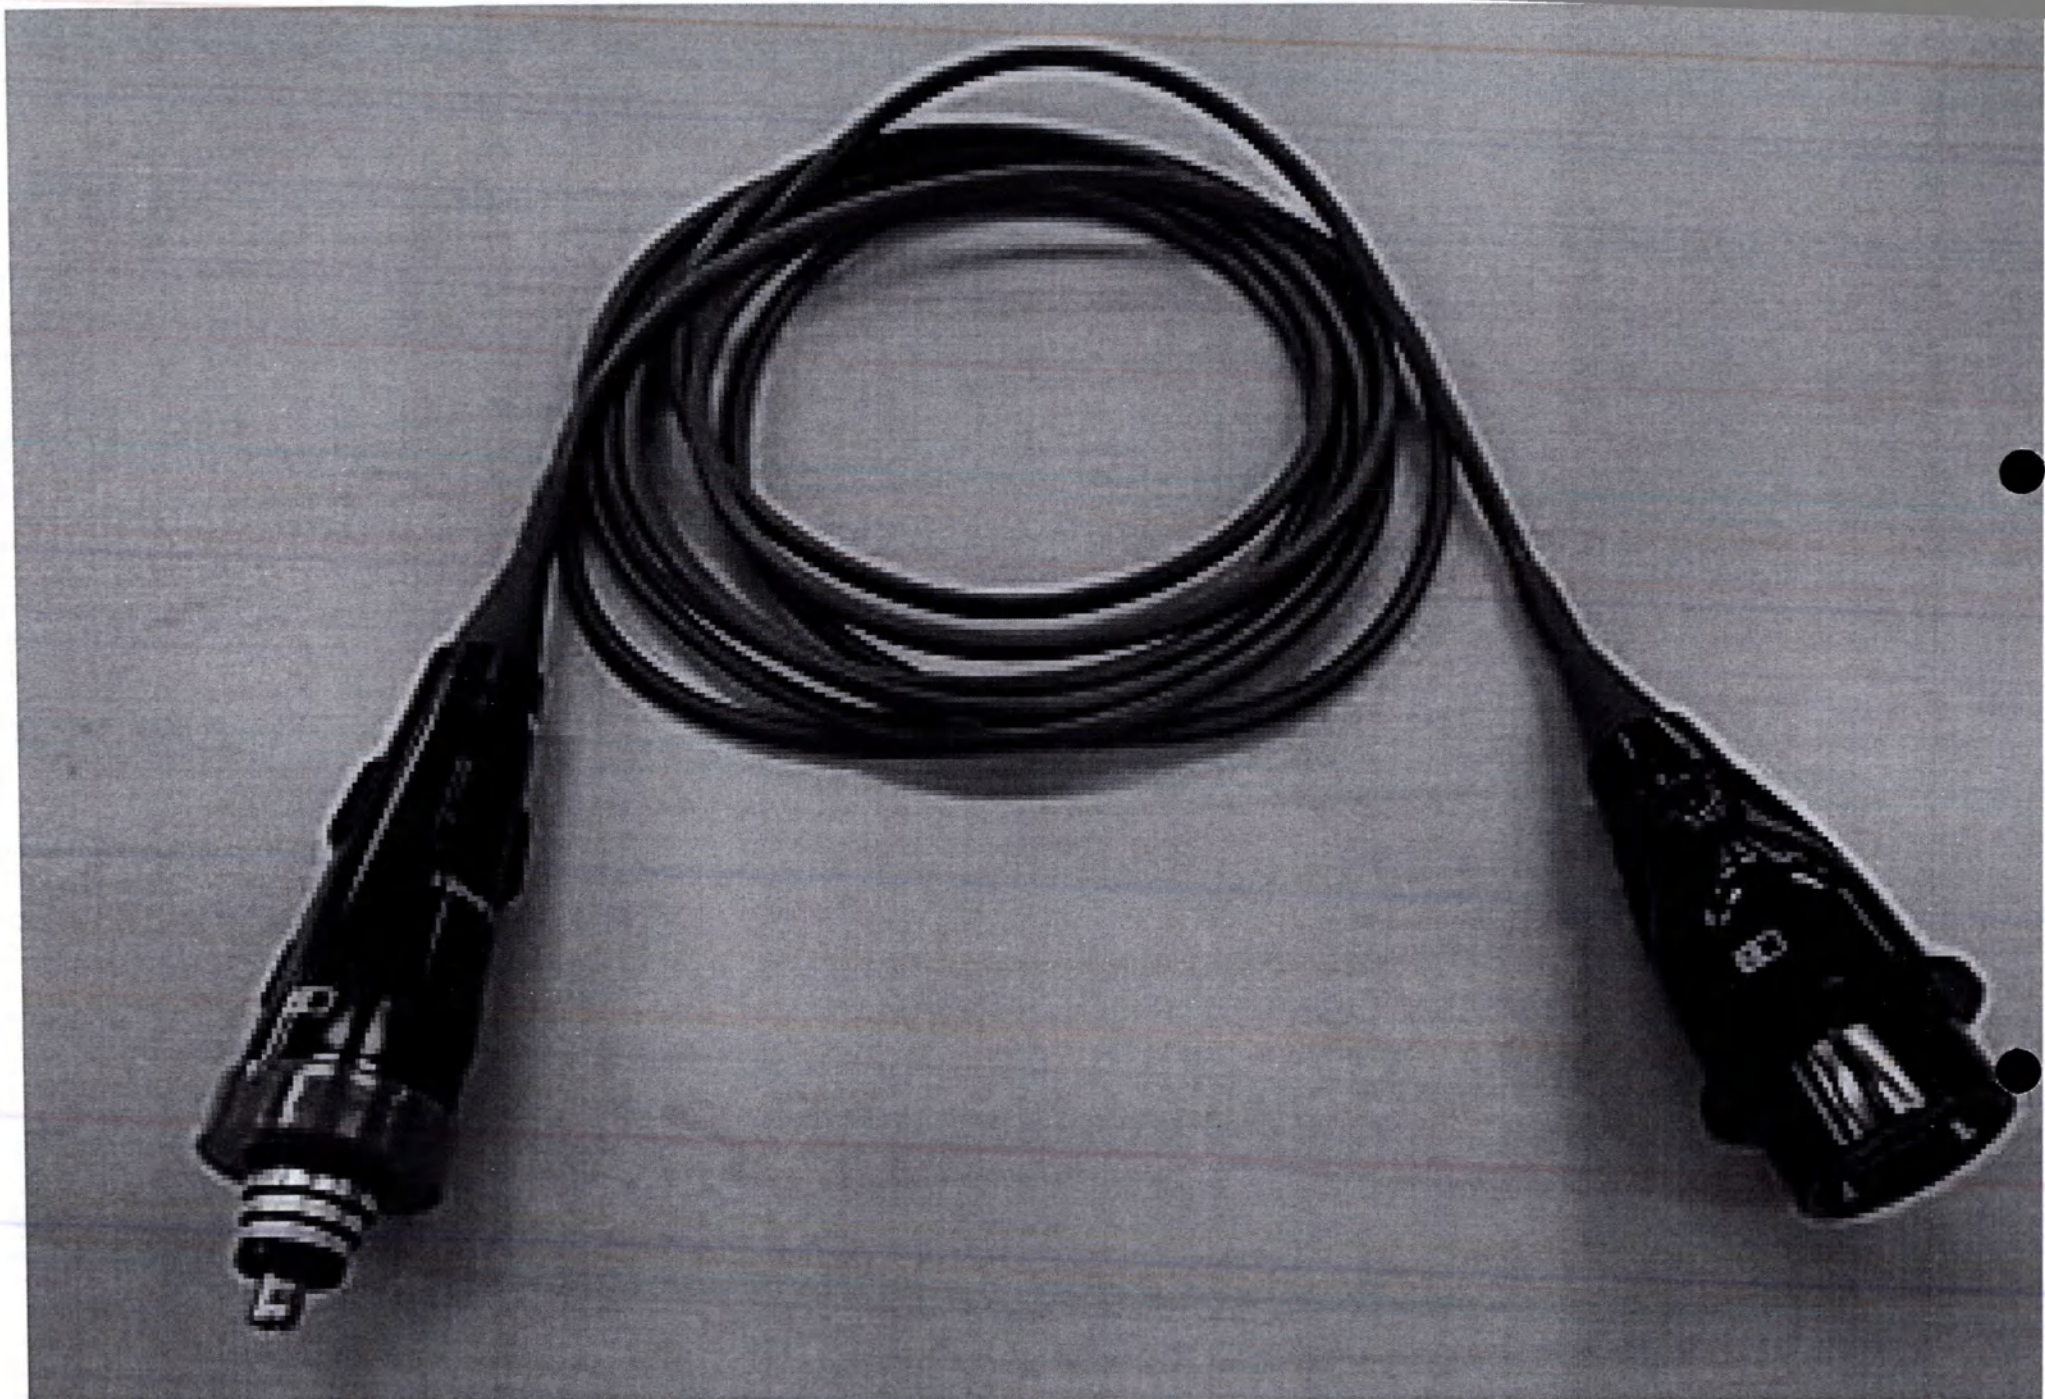

Трансдюсер: TD-SB400.

Трансдюсер: TD-SB400 (макет маркировки)

Артикул	Трансдюсер: TD-SB400
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

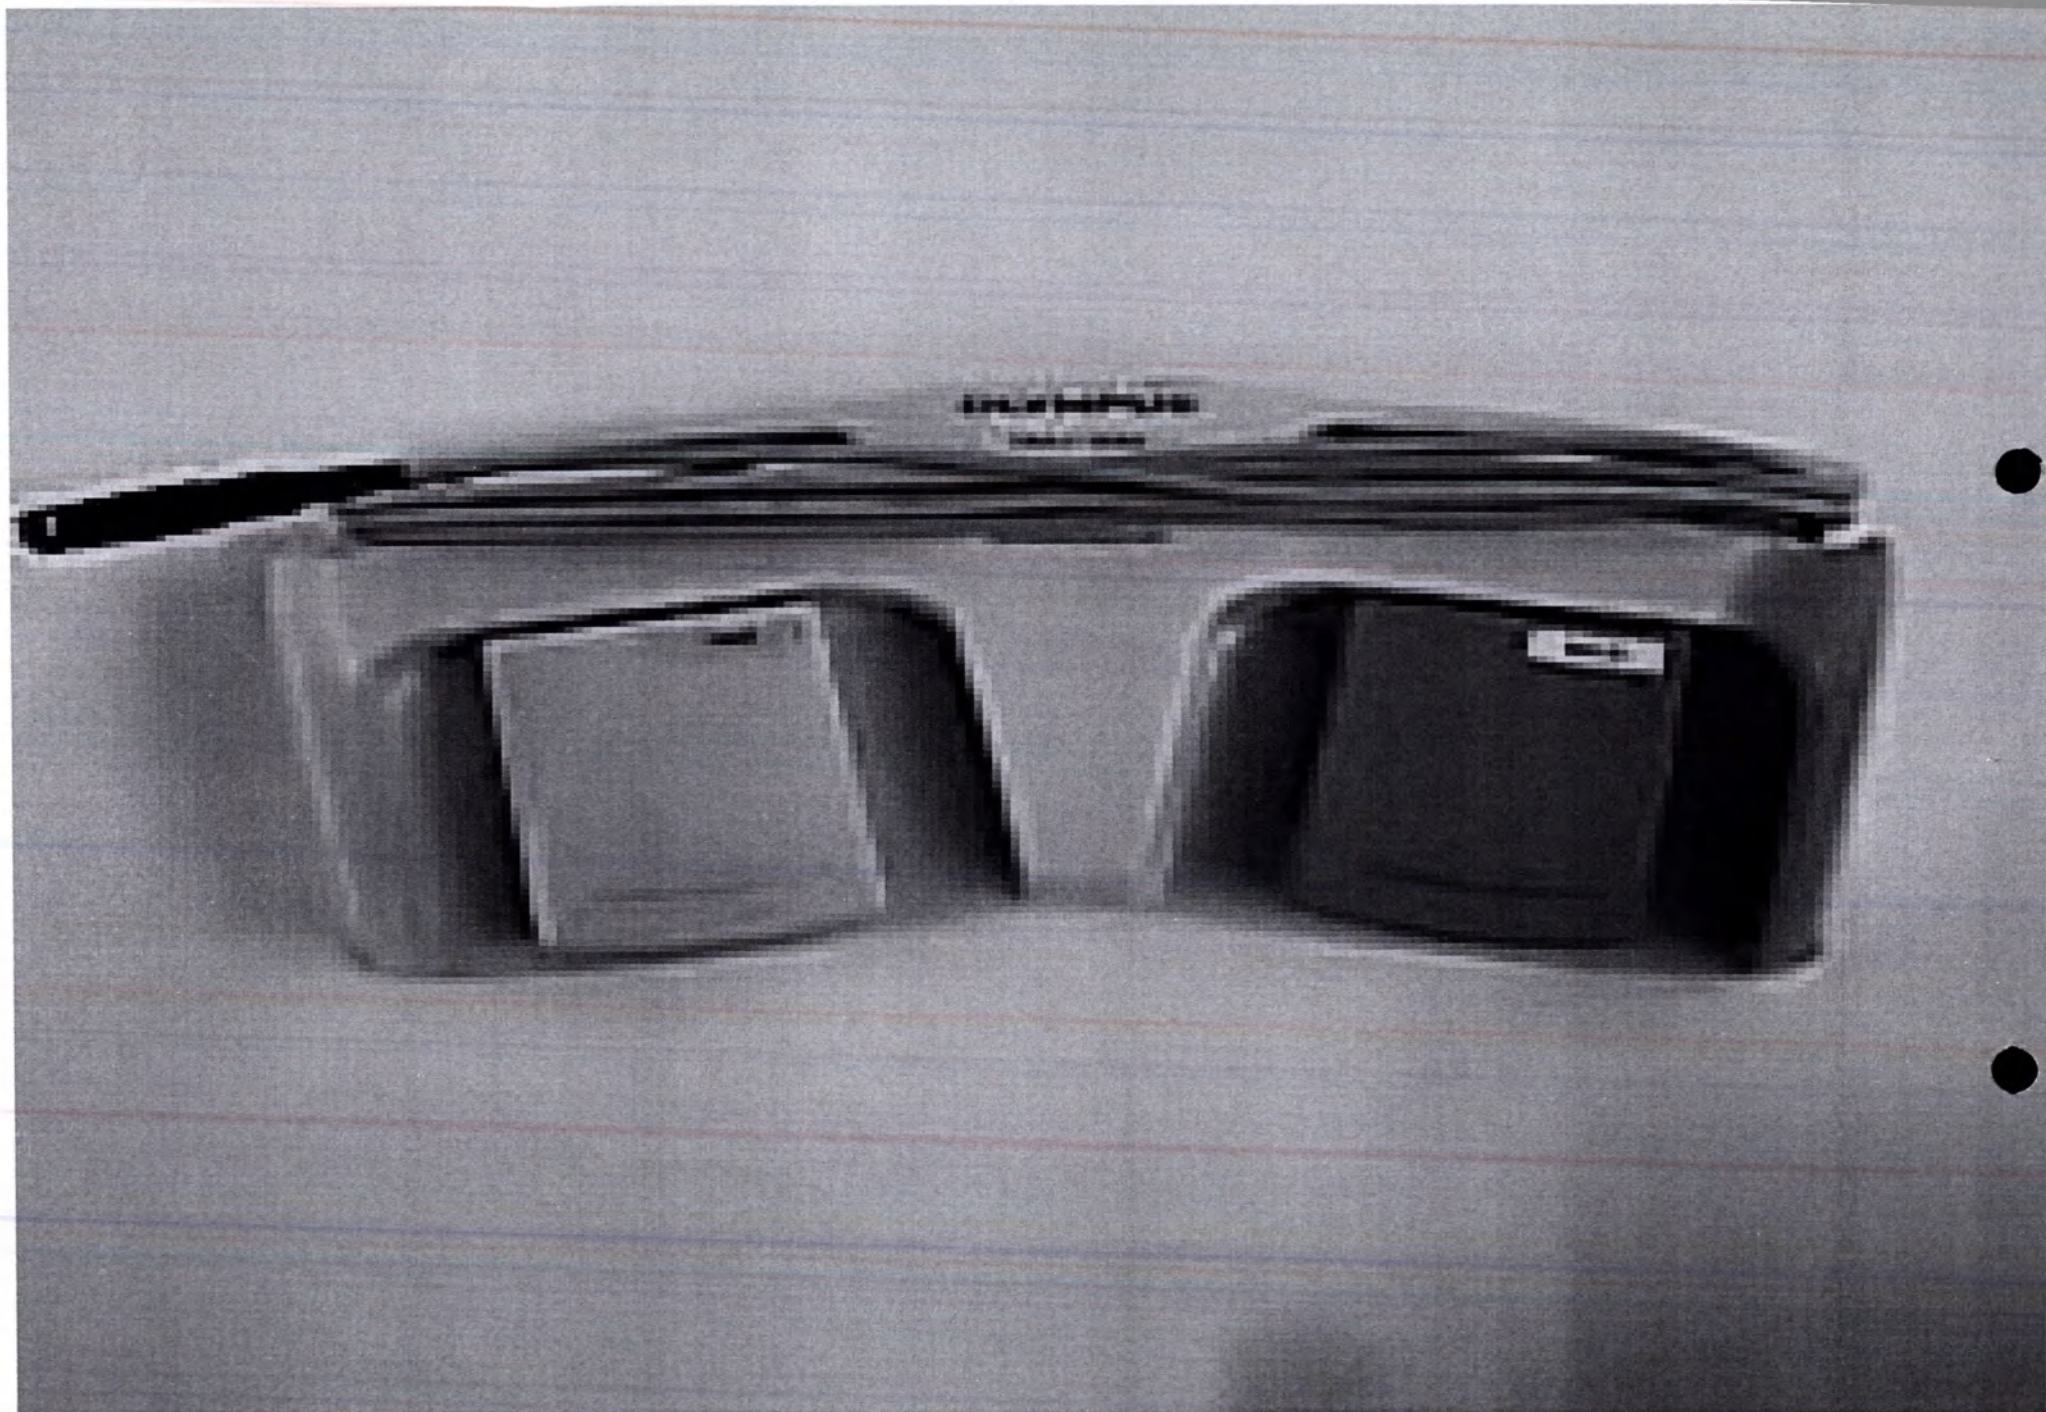

Ножной переключатель: MAJ-1869.

Ножной переключатель: MAJ-1869. (макет маркировки)

Артикул	Ножной переключатель: MAJ-1869
Наименование	Инструменты эндохирургические с принадлежностями
Производитель	«Олимпас Винтер энд Ибе Гмбх»
Адрес производителя	Кюнштрассе 61, 22045 Гамбург, Германия
Страна происхождения	Германия
Регистрационное удостоверение	РЗН № 2015/3467
Импортер	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	Серийный номер см. на упаковке (опционально)
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	Дата изготовления см. на упаковке (опционально)
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



Григорьев

ПРОШУ И
СКРЕПЛЕНО
ЛИСТОВ

162 (сто шестидесяти две)