

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.



» 2021 г.

Фотографические изображения

«Электрод для кардиостимуляции Attain различных размеров»

Производства:

«Медтроник Инк.», США

Medtronic Inc. 710 Medtronic Parkway, Minneapolis MN 55432 USA

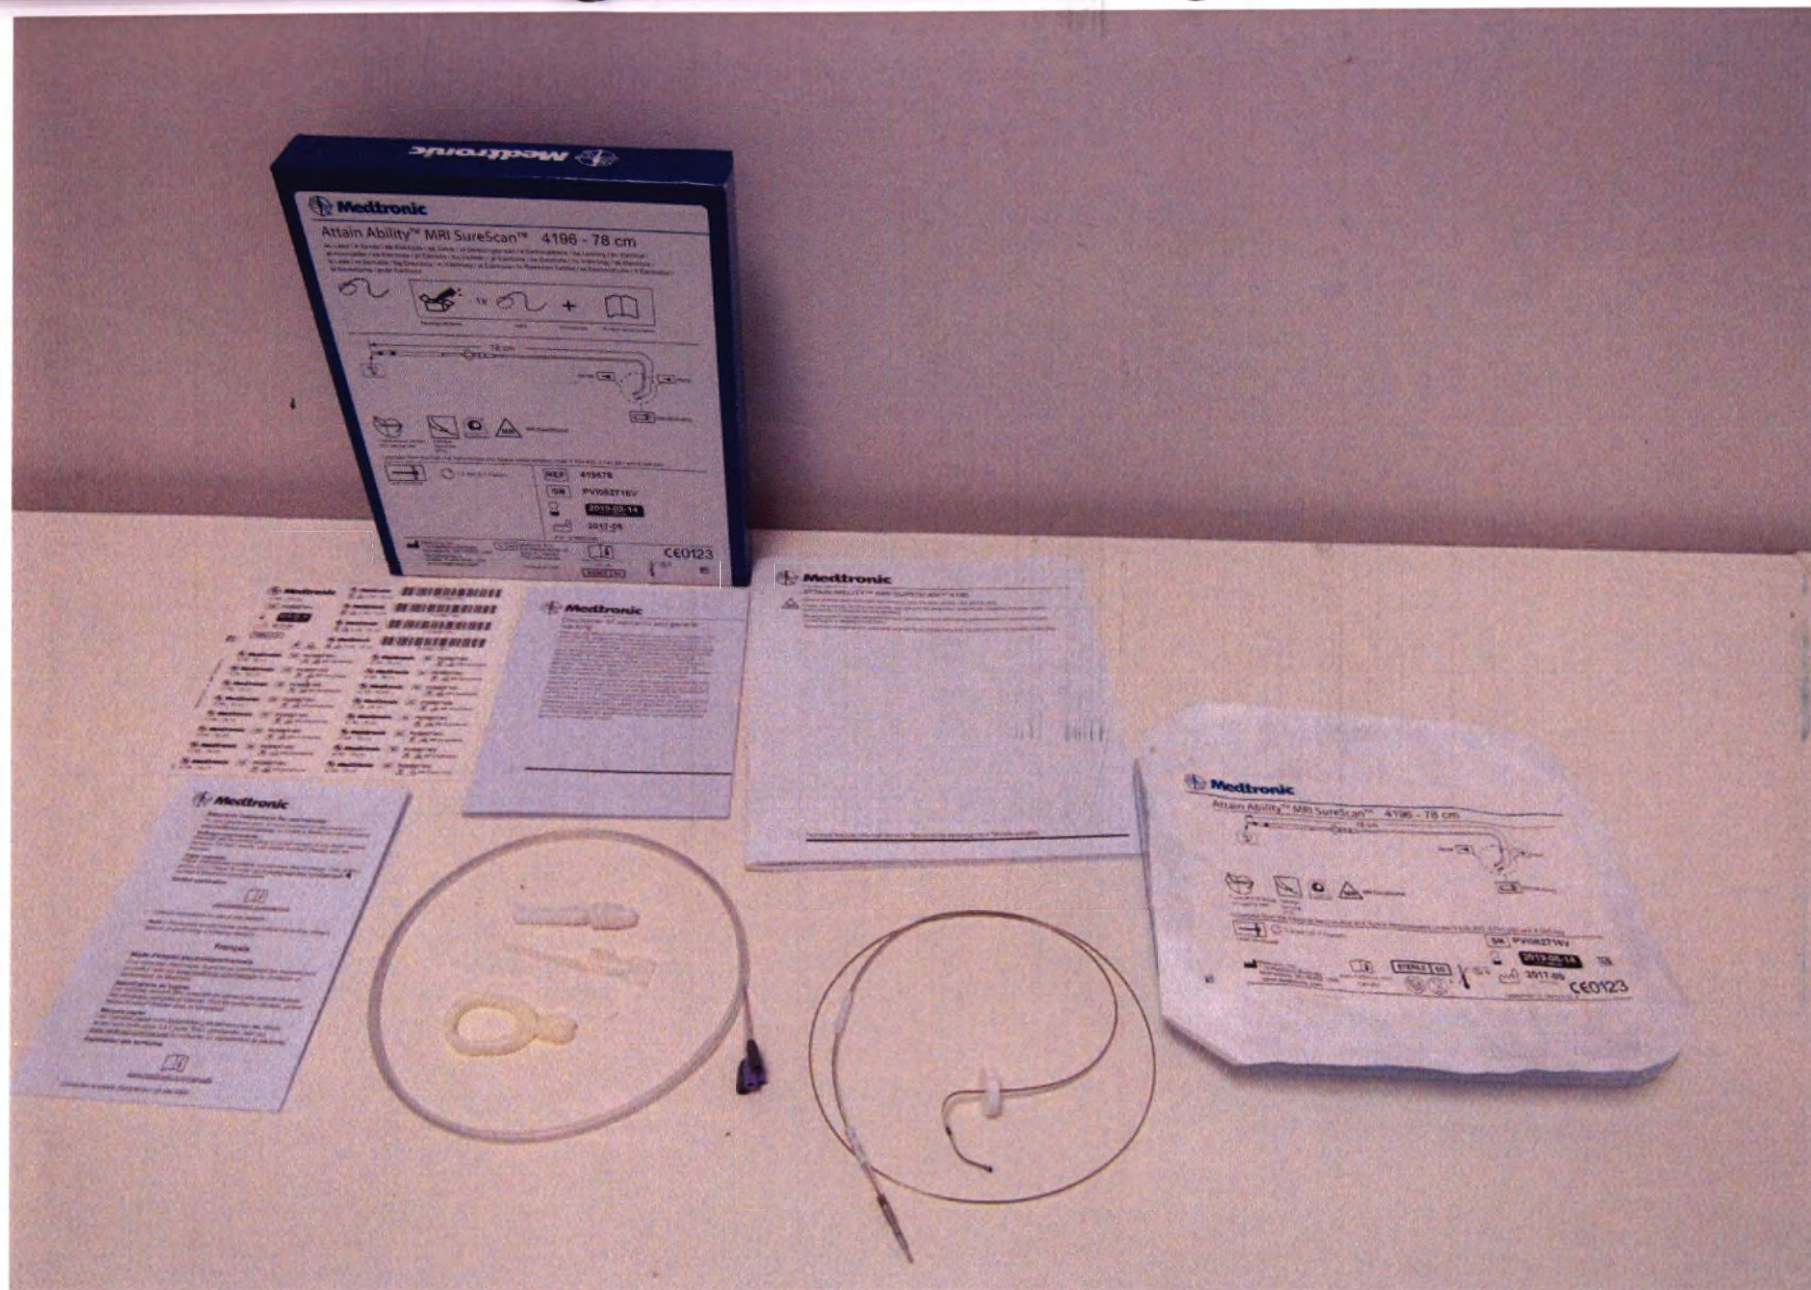


Рисунок 1. Общий вид: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability MRI SureScan, модель 4196, длина: 78 см, в составе: электрод с фиксирующей муфтой; инструмент для введения проволочного проводника; зажим проволочного проводника; рукоятка проволочным проводником; дополнительные стилеты – до 6 шт.; документация по продукту.



Рисунок 2. Стерильная упаковка: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability MRI SureScan, модель 4196, длина: 78 см



Рисунок 3. Маркировка стерильной упаковки: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability MRI SureScan, модель 4196, длина: 78 см

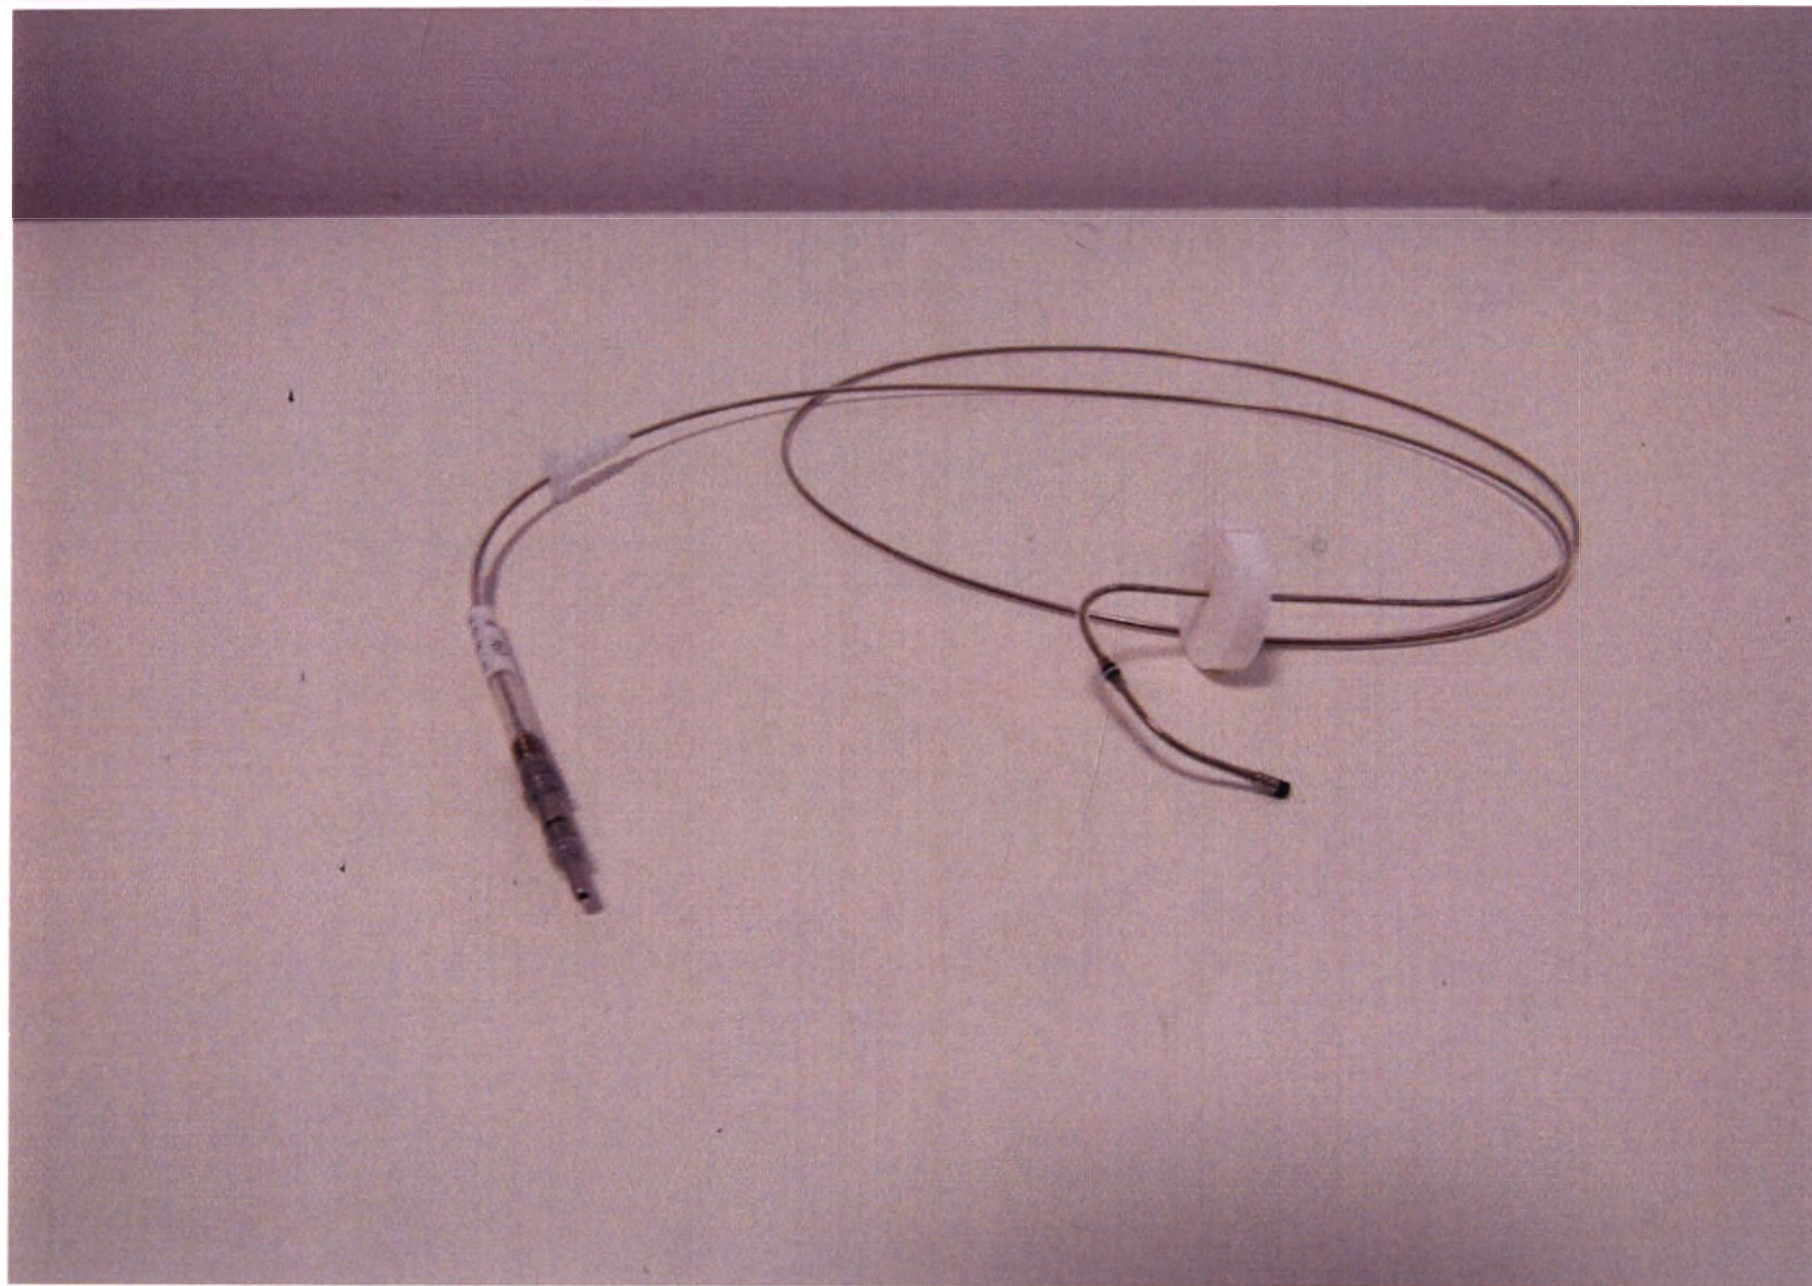


Рисунок 5. Электрод с фиксирующей муфтой

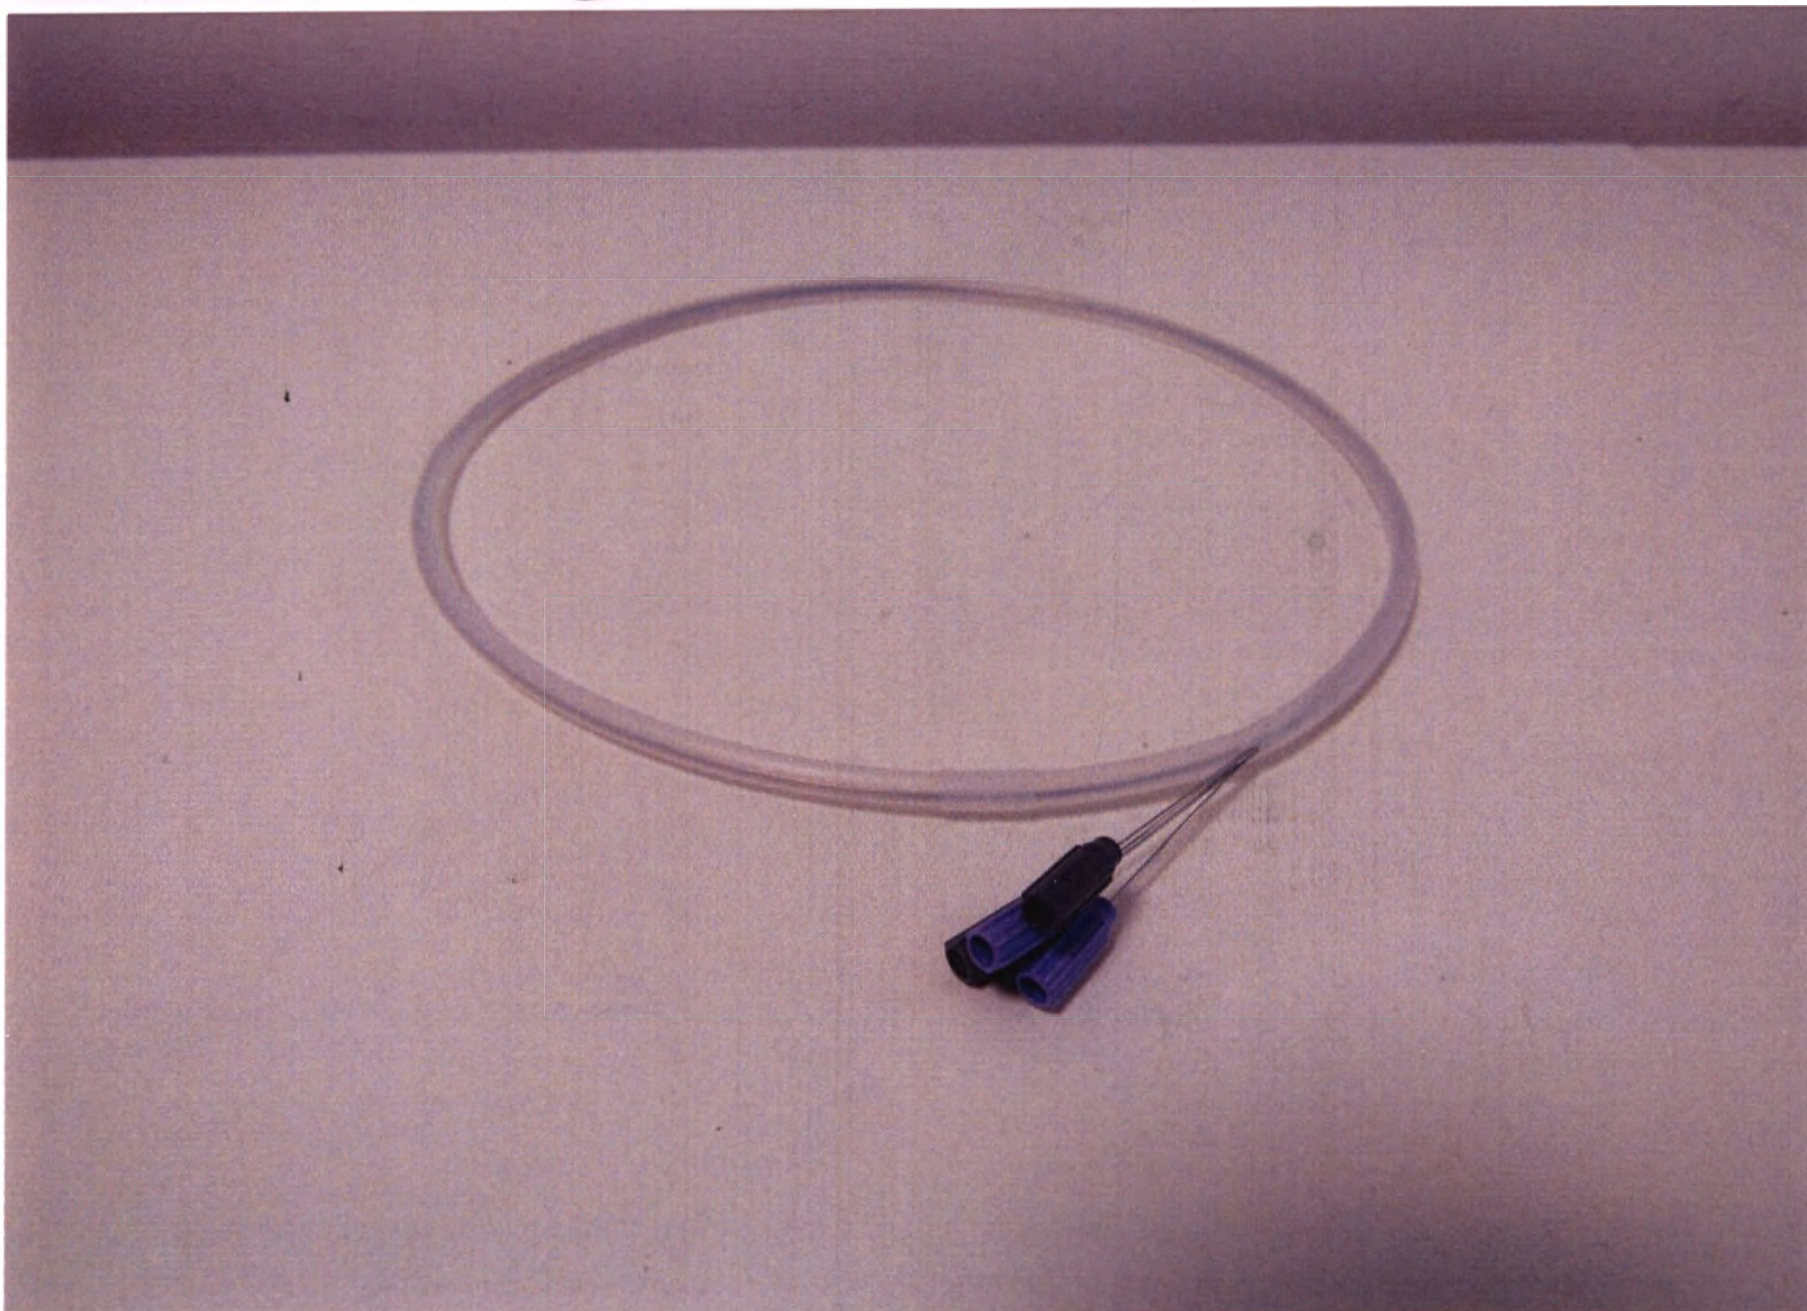


Рисунок 6. Дополнительные стилеты

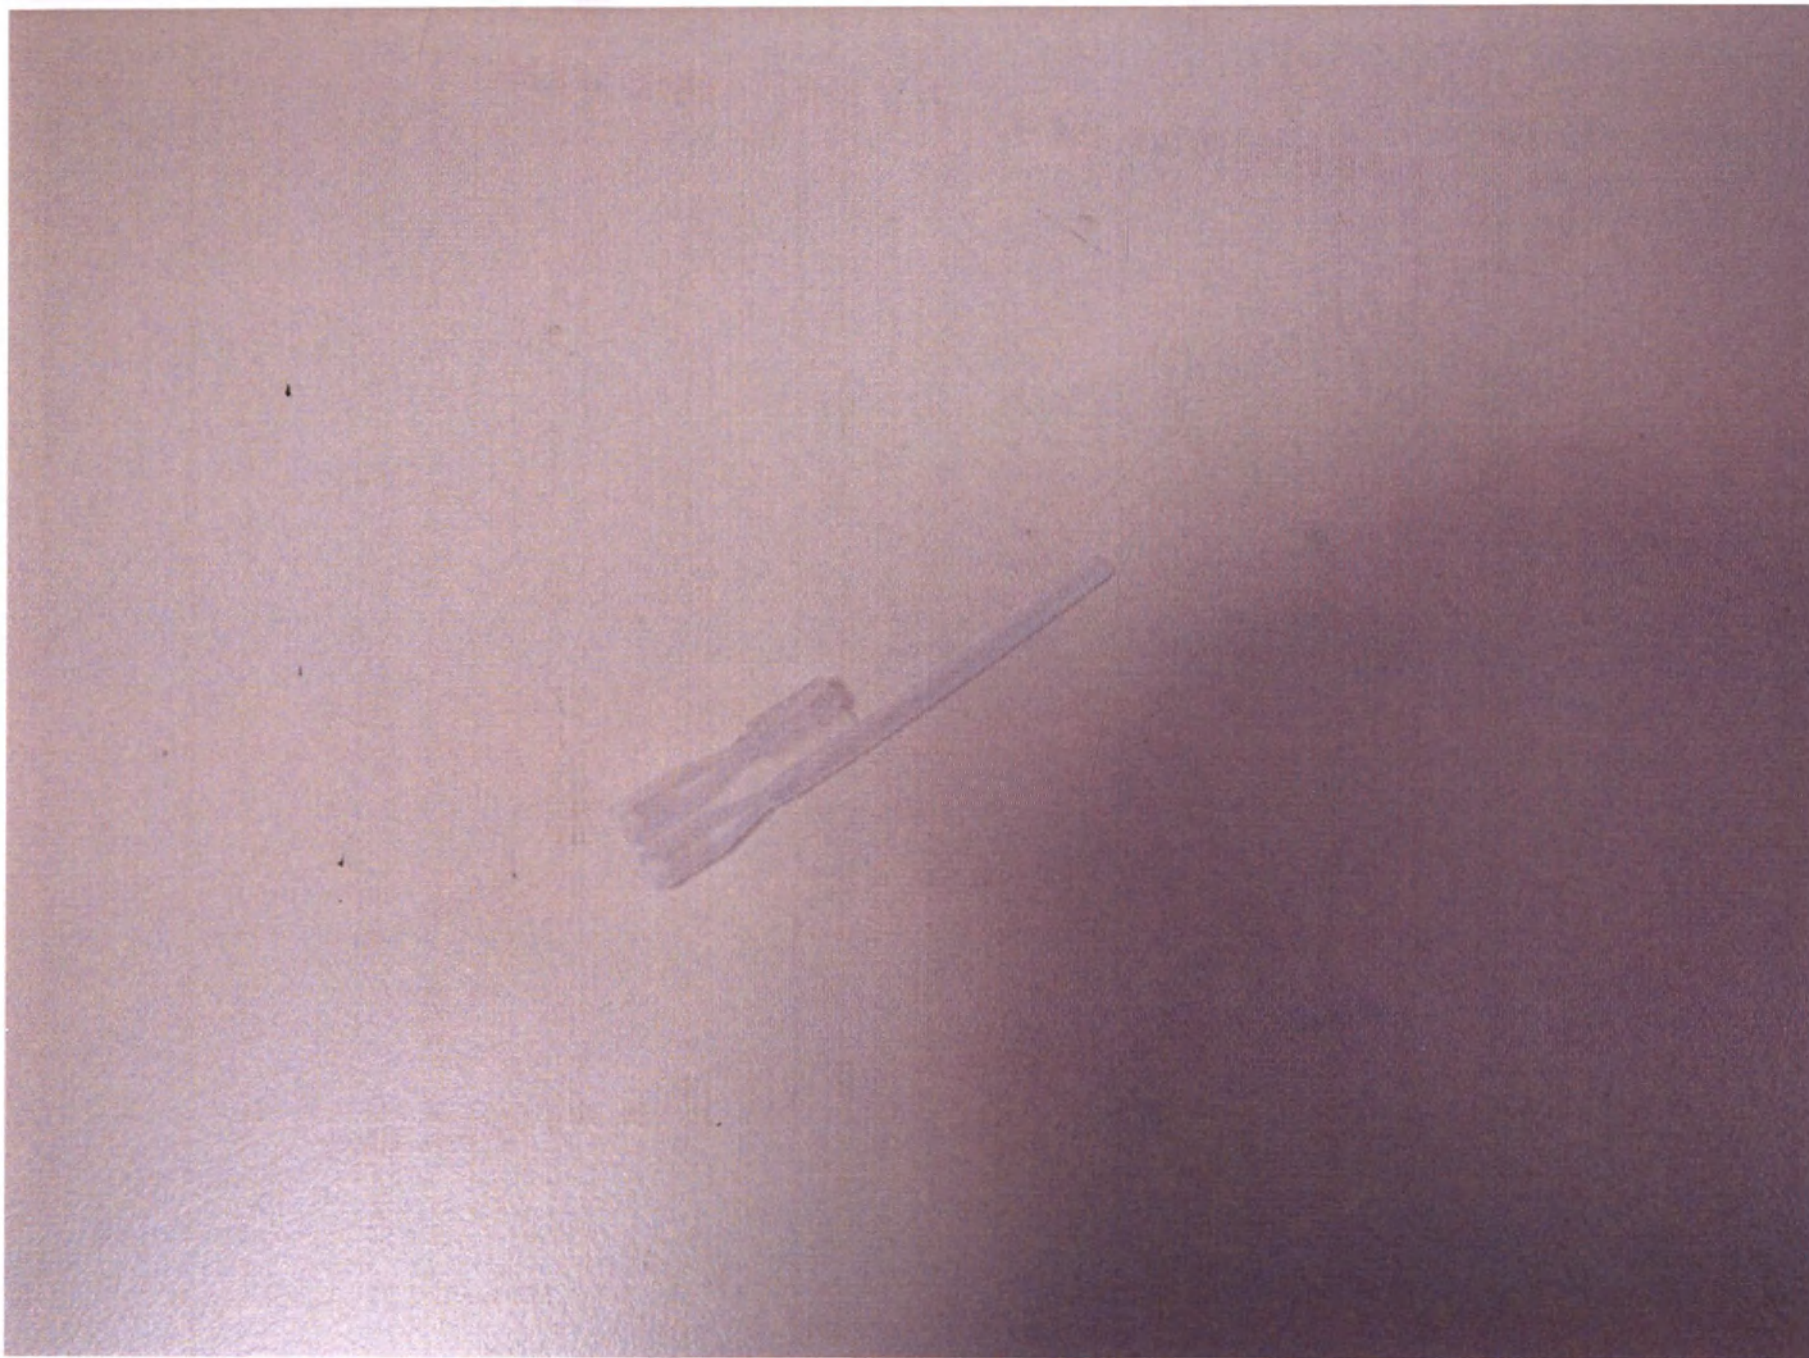


Рисунок 7. Инструмент для введения проволочного проводника

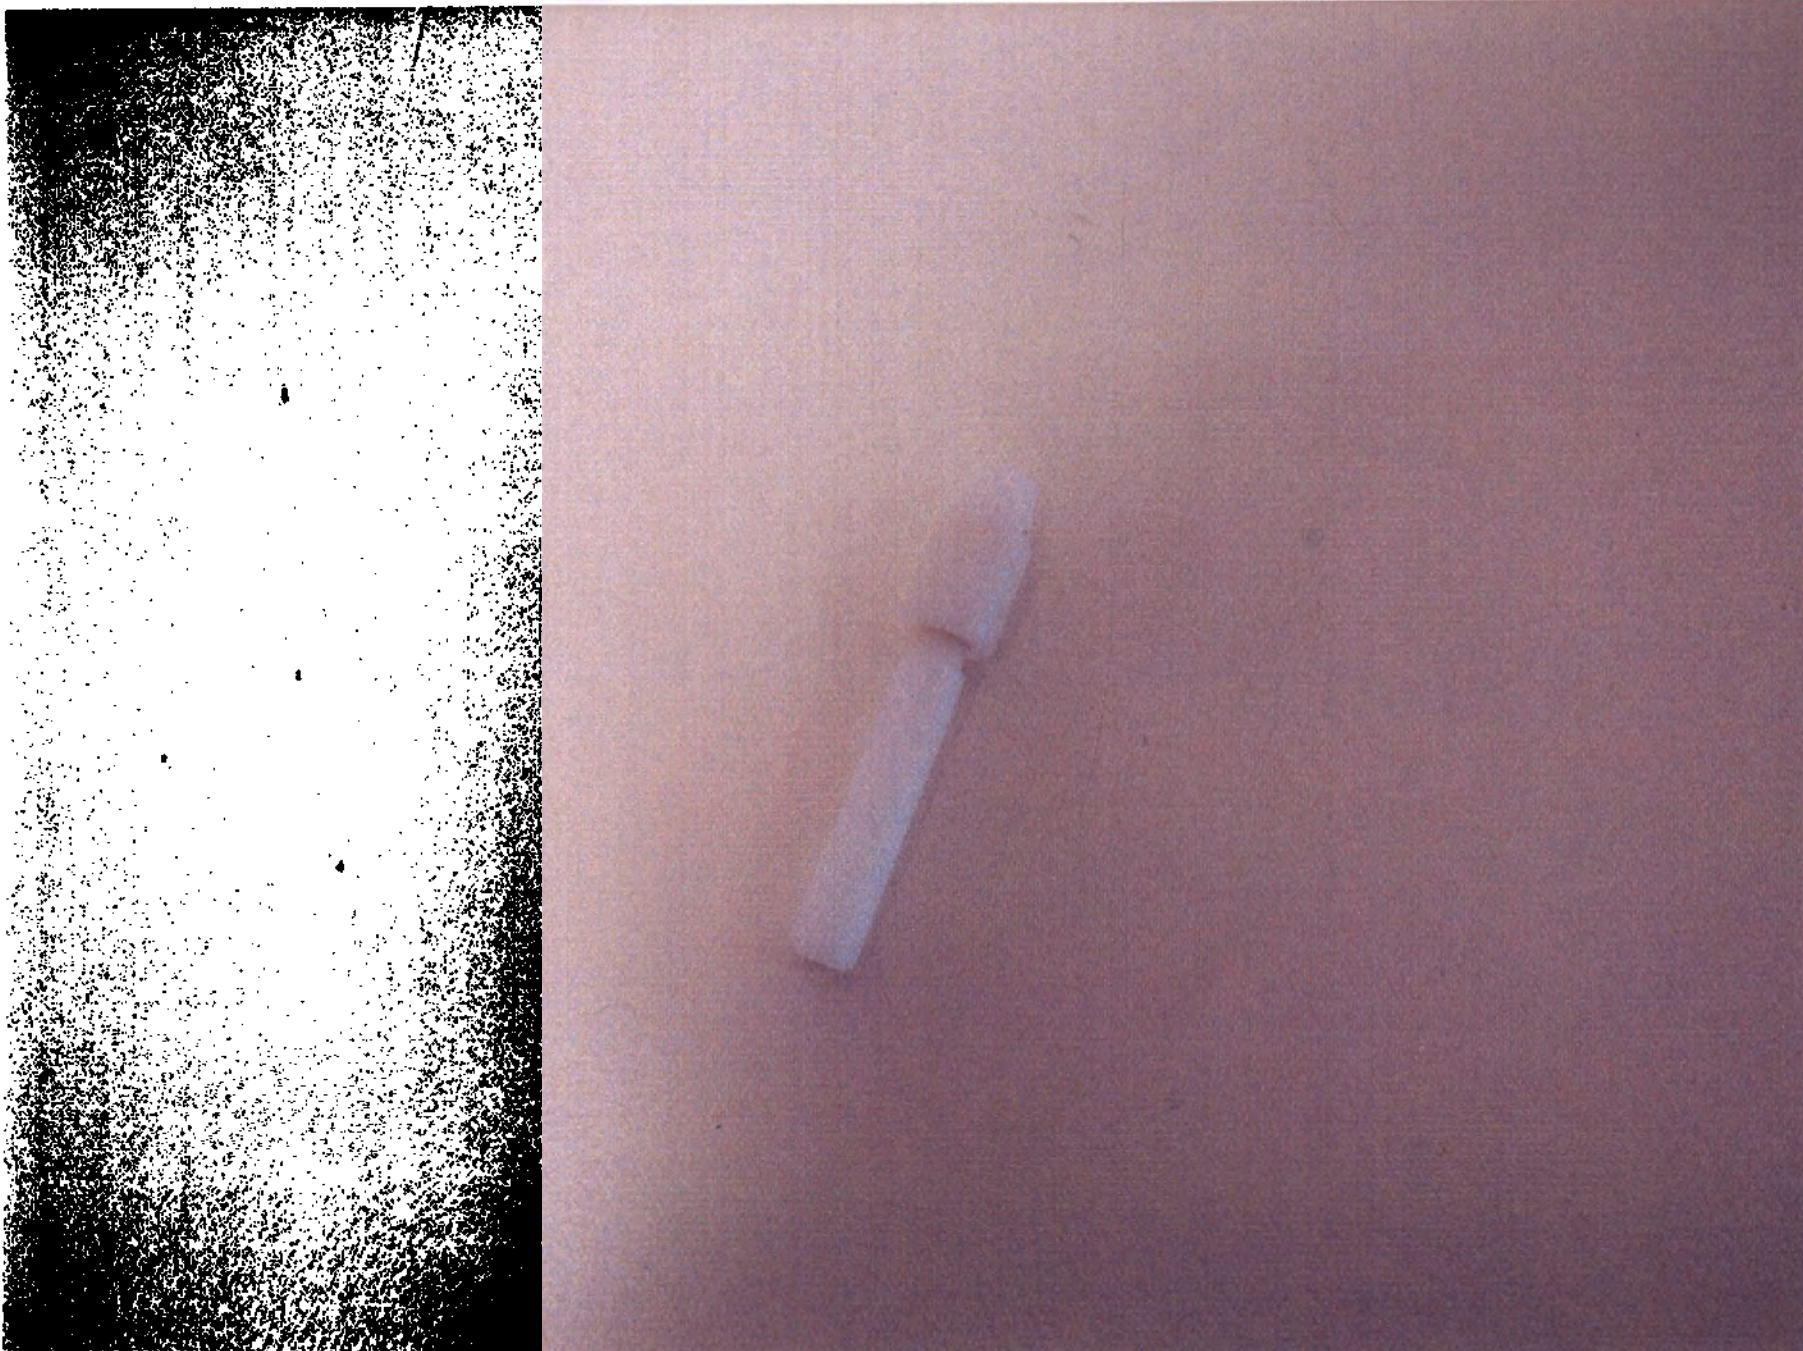


Рисунок 8. Рукоятка управления проволочным проводником

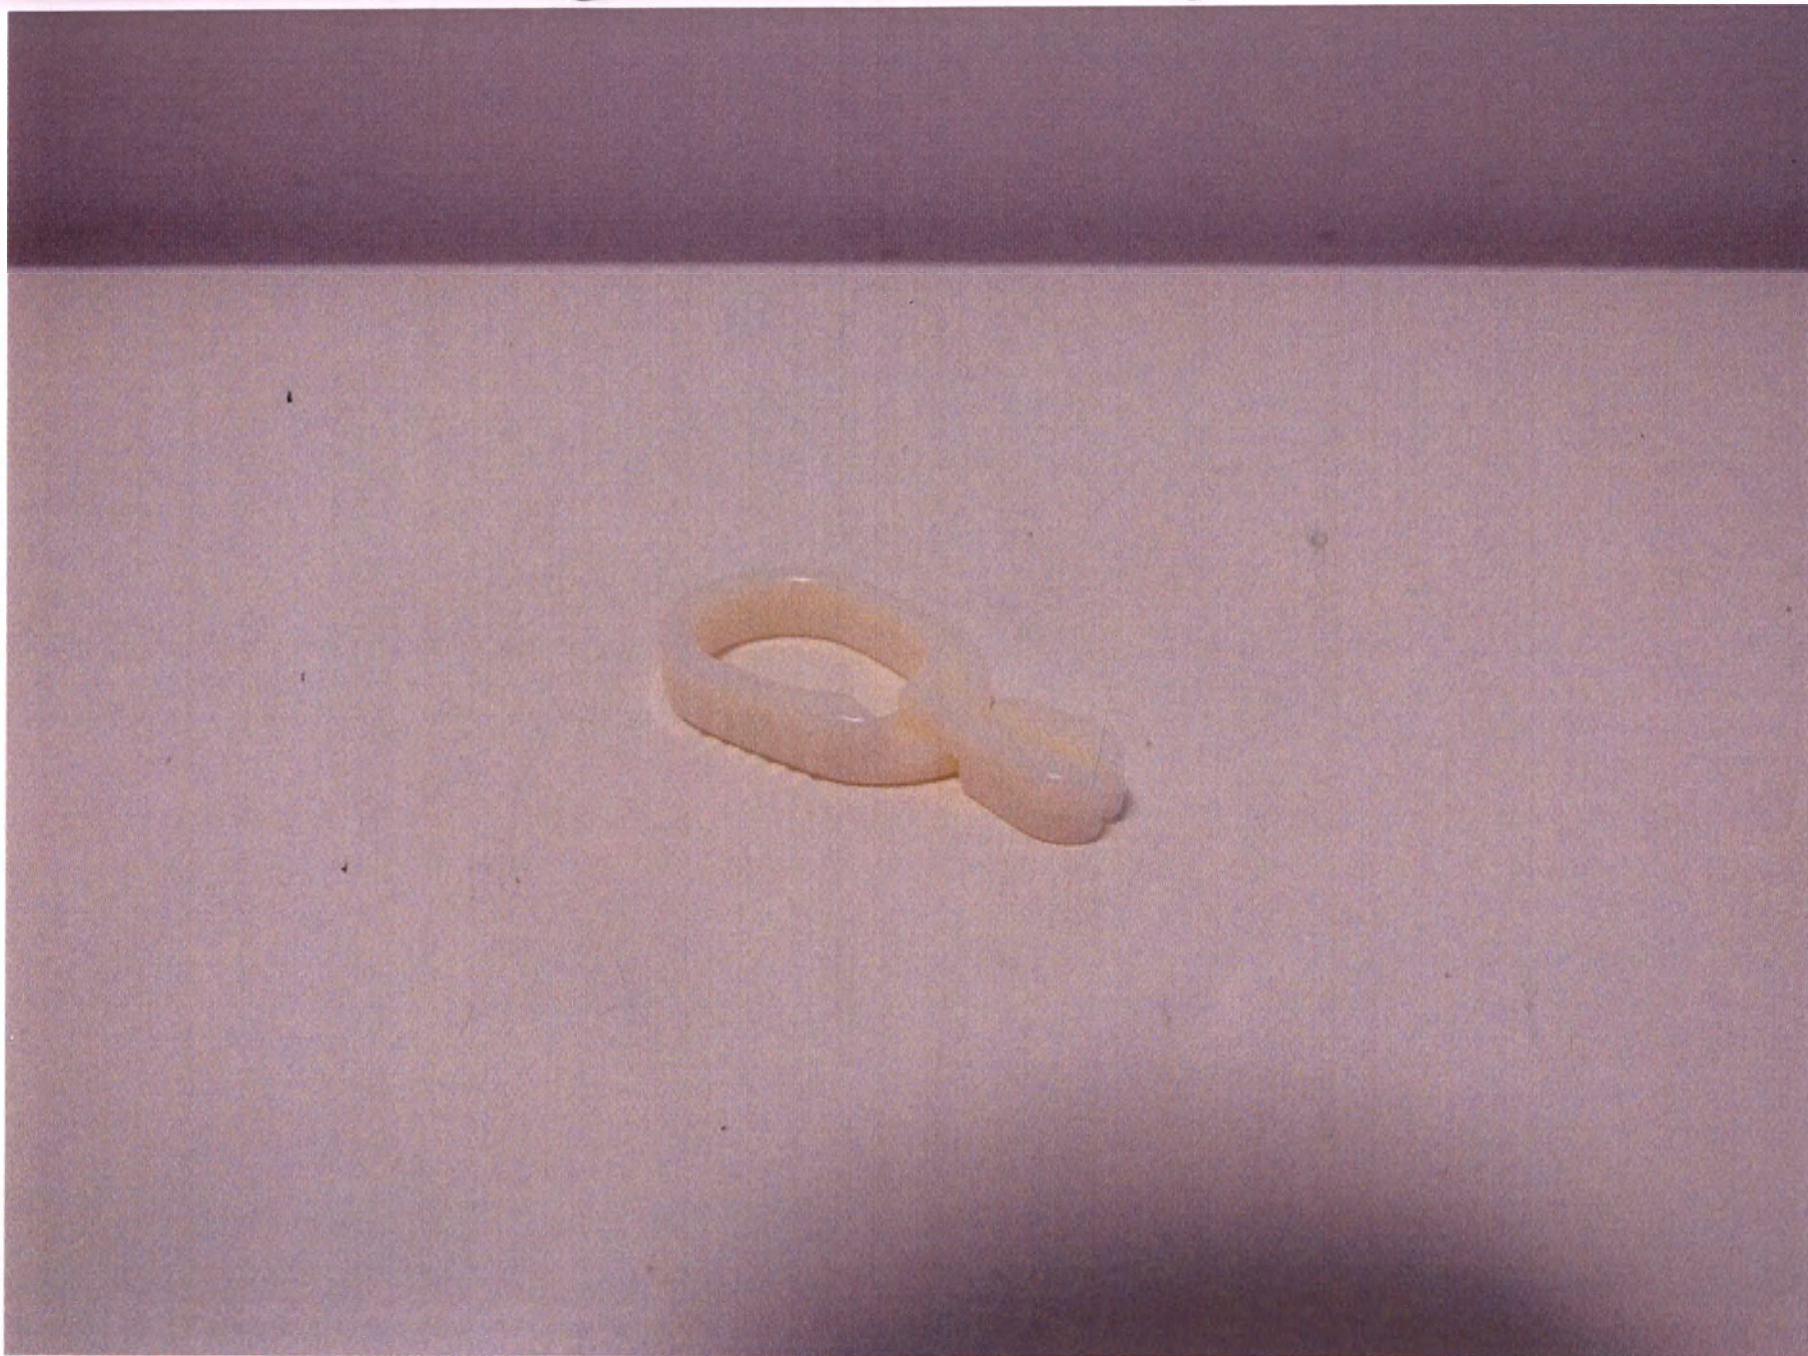


Рисунок 9. Зажим проволочного проводника

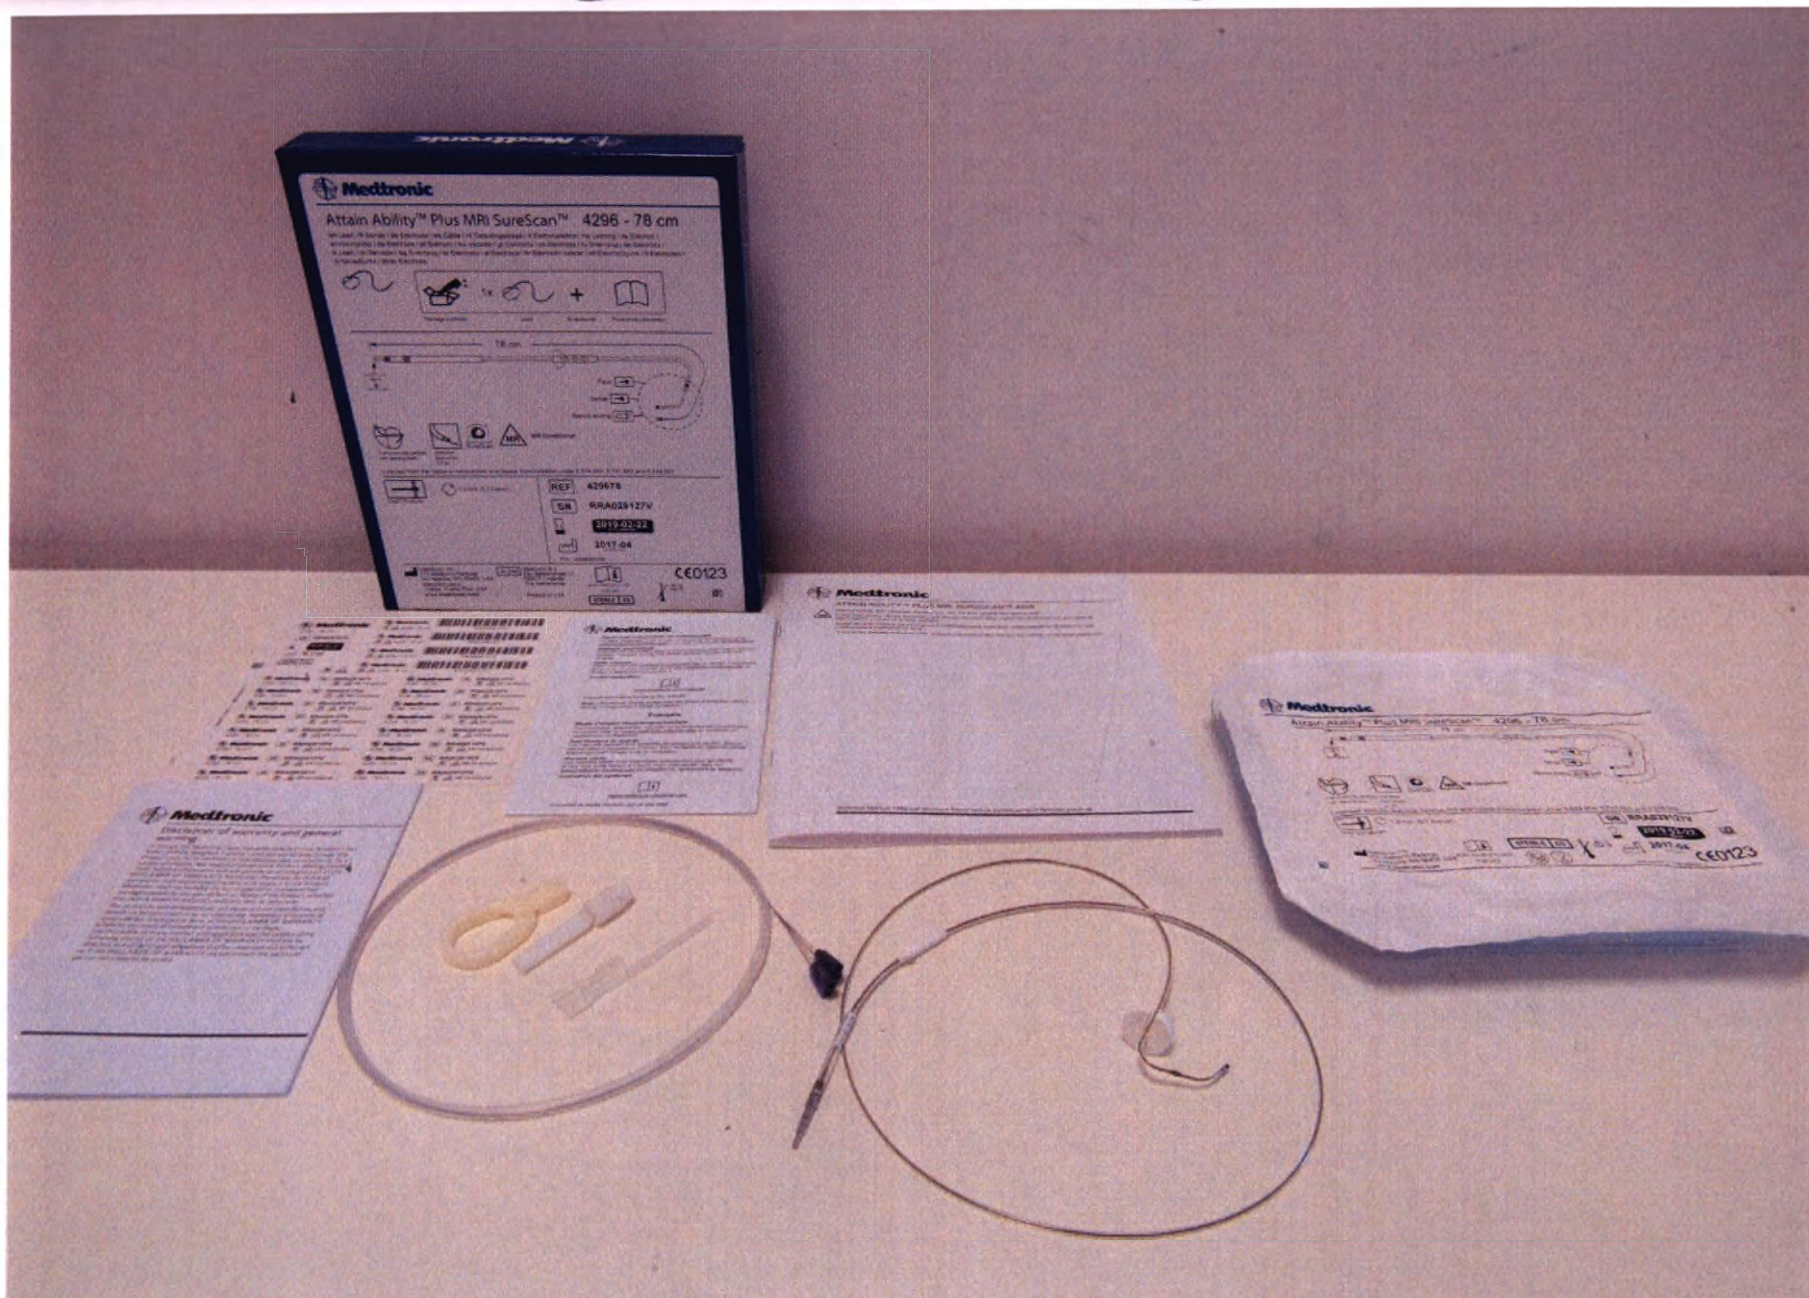


Рисунок 10. Общий вид: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Plus MRI SureScan, модель 4296, длина: 78 см, в составе: электрод с фиксирующей муфтой; инструмент для введения проволоочного проводника; зажим проволоочного проводника; ления проволоочным проводником; дополнительные стилеты – до 6 шт.; документация по продукту.



Рисунок 11. Стерильная упаковка: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Plus MRI SureScan, модель 4296, длина: 78 см



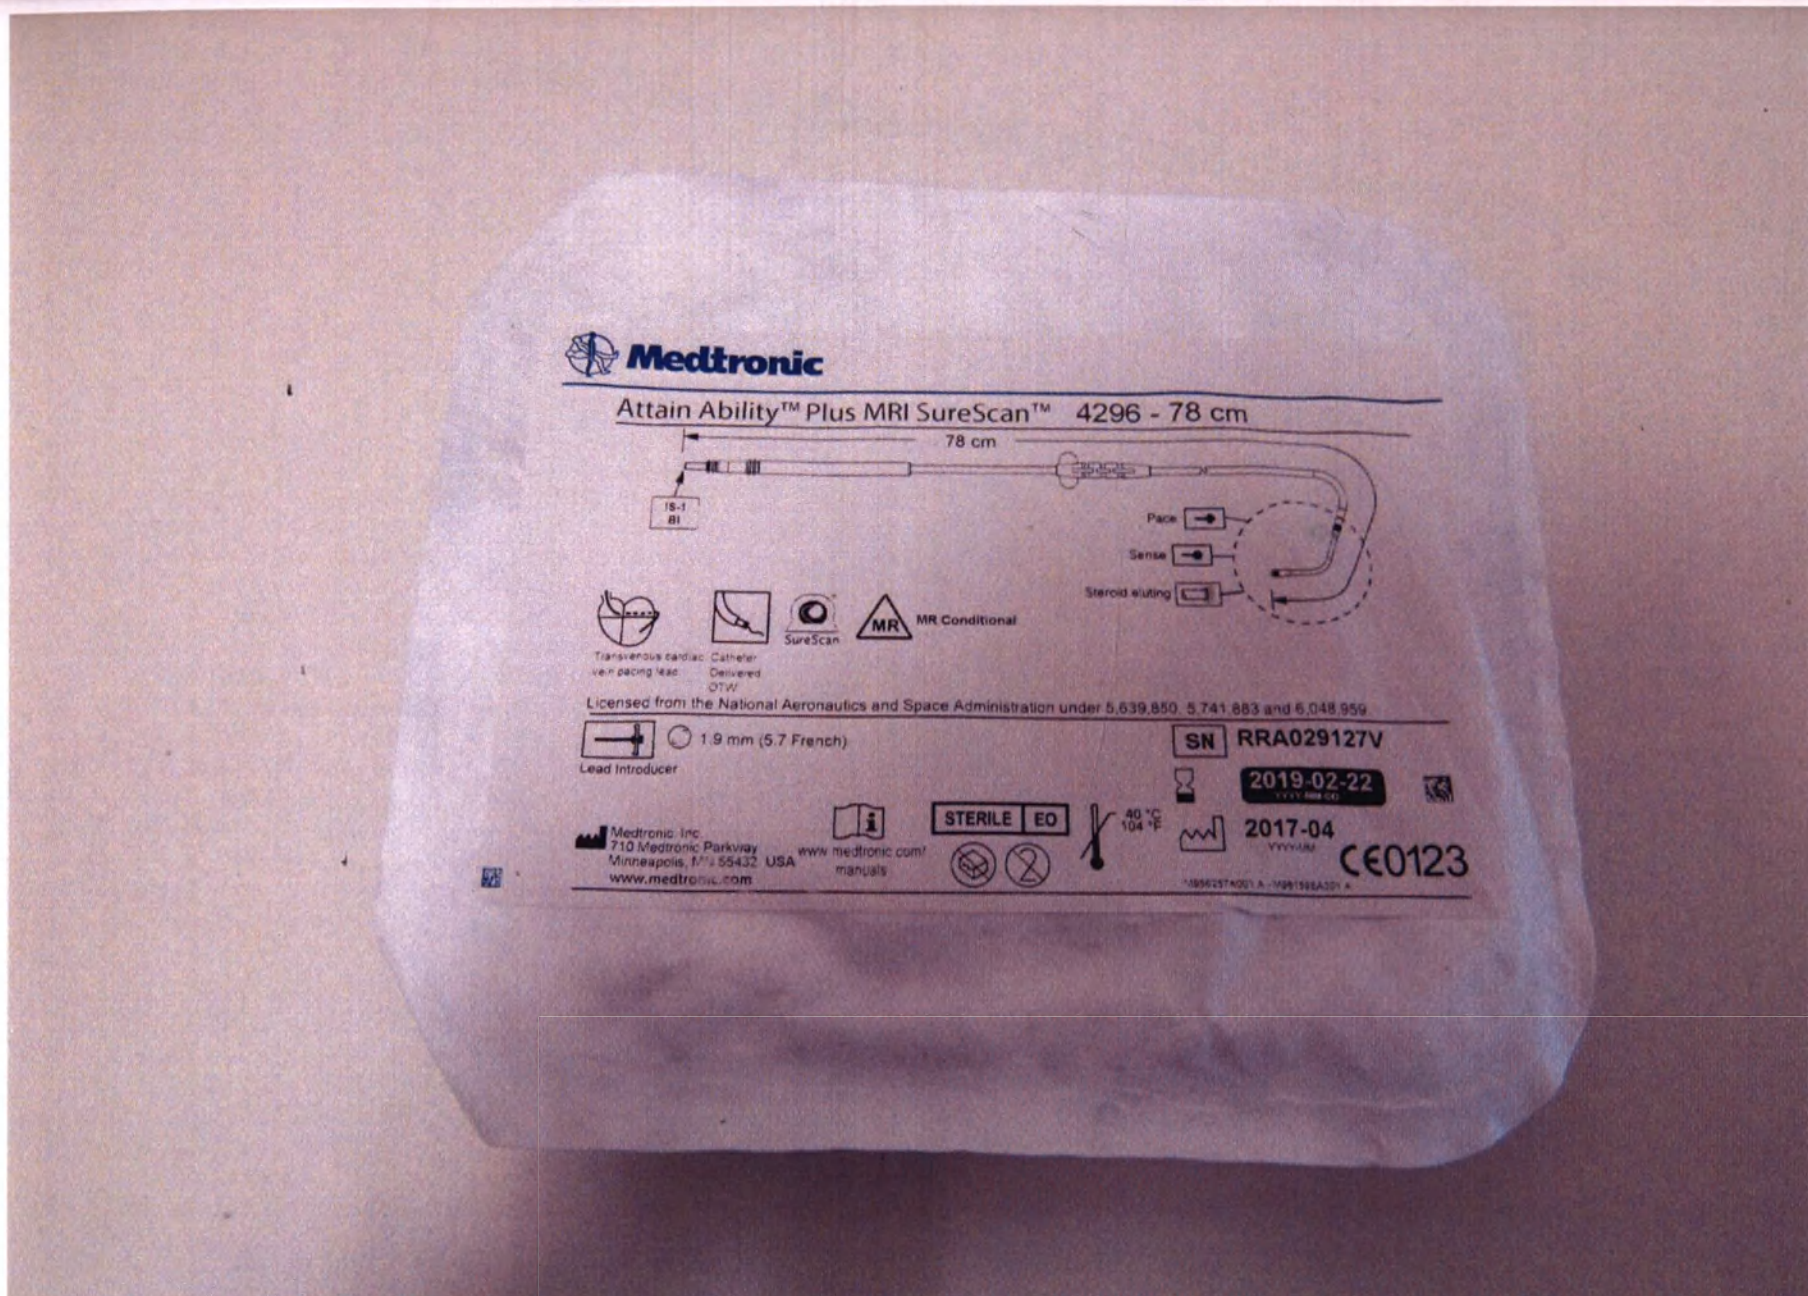


Рисунок 12. Маркировка стерильной упаковки: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Plus MRI SureScan, модель 4296, длина: 78 см




Attain Ability™ Plus MRI SureScan™ 4296 - 78 cm

en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidsdraad / it Electrocatetere / no Ledning / sv Elektrod /
el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Electrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / es Elektroda / ru Электрод / sk Elektroda /
fr Lead / ro Derivaj / bg Elektroda / sr Elektroda / sl Elektroda / hr Elektrodi kateter / et Elektrodijube / lt Elektroda /
lv Novadījuma / pt-br Electrodo



1x



+




Package contents:

Lead

Accessories

Product documentation

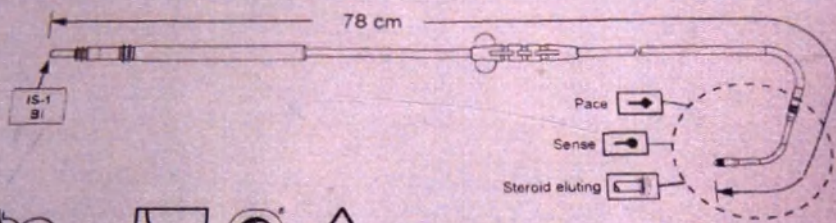

Transvenous cardiac
ven pacing lead




Catheter
Delivered
OTW



MR Conditional

Licensed from the National Aeronautics and Space Administration under 5,639,850; 5,741,883 and 6,048,959



Lead introducer



1.9 mm (5.7 French)

REF

429678

SN

RRA029127V



2019-02-22
YYYY-MM-DD



2017-04
YYYY-MM

PIN 4296000039



Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
Manufactured in:
Villalba, Puerto Rico, USA
www.medtronic.com



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

Product of USA



www.medtronic.com
manuals

STERILE EO

CE0123



40 °C
104 °F

M362574001-A - M3615884001-A

Рисунок 13. Маркировка потребительской упаковки: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Plus MRI SureScan, модель 4296, длина: 78 см

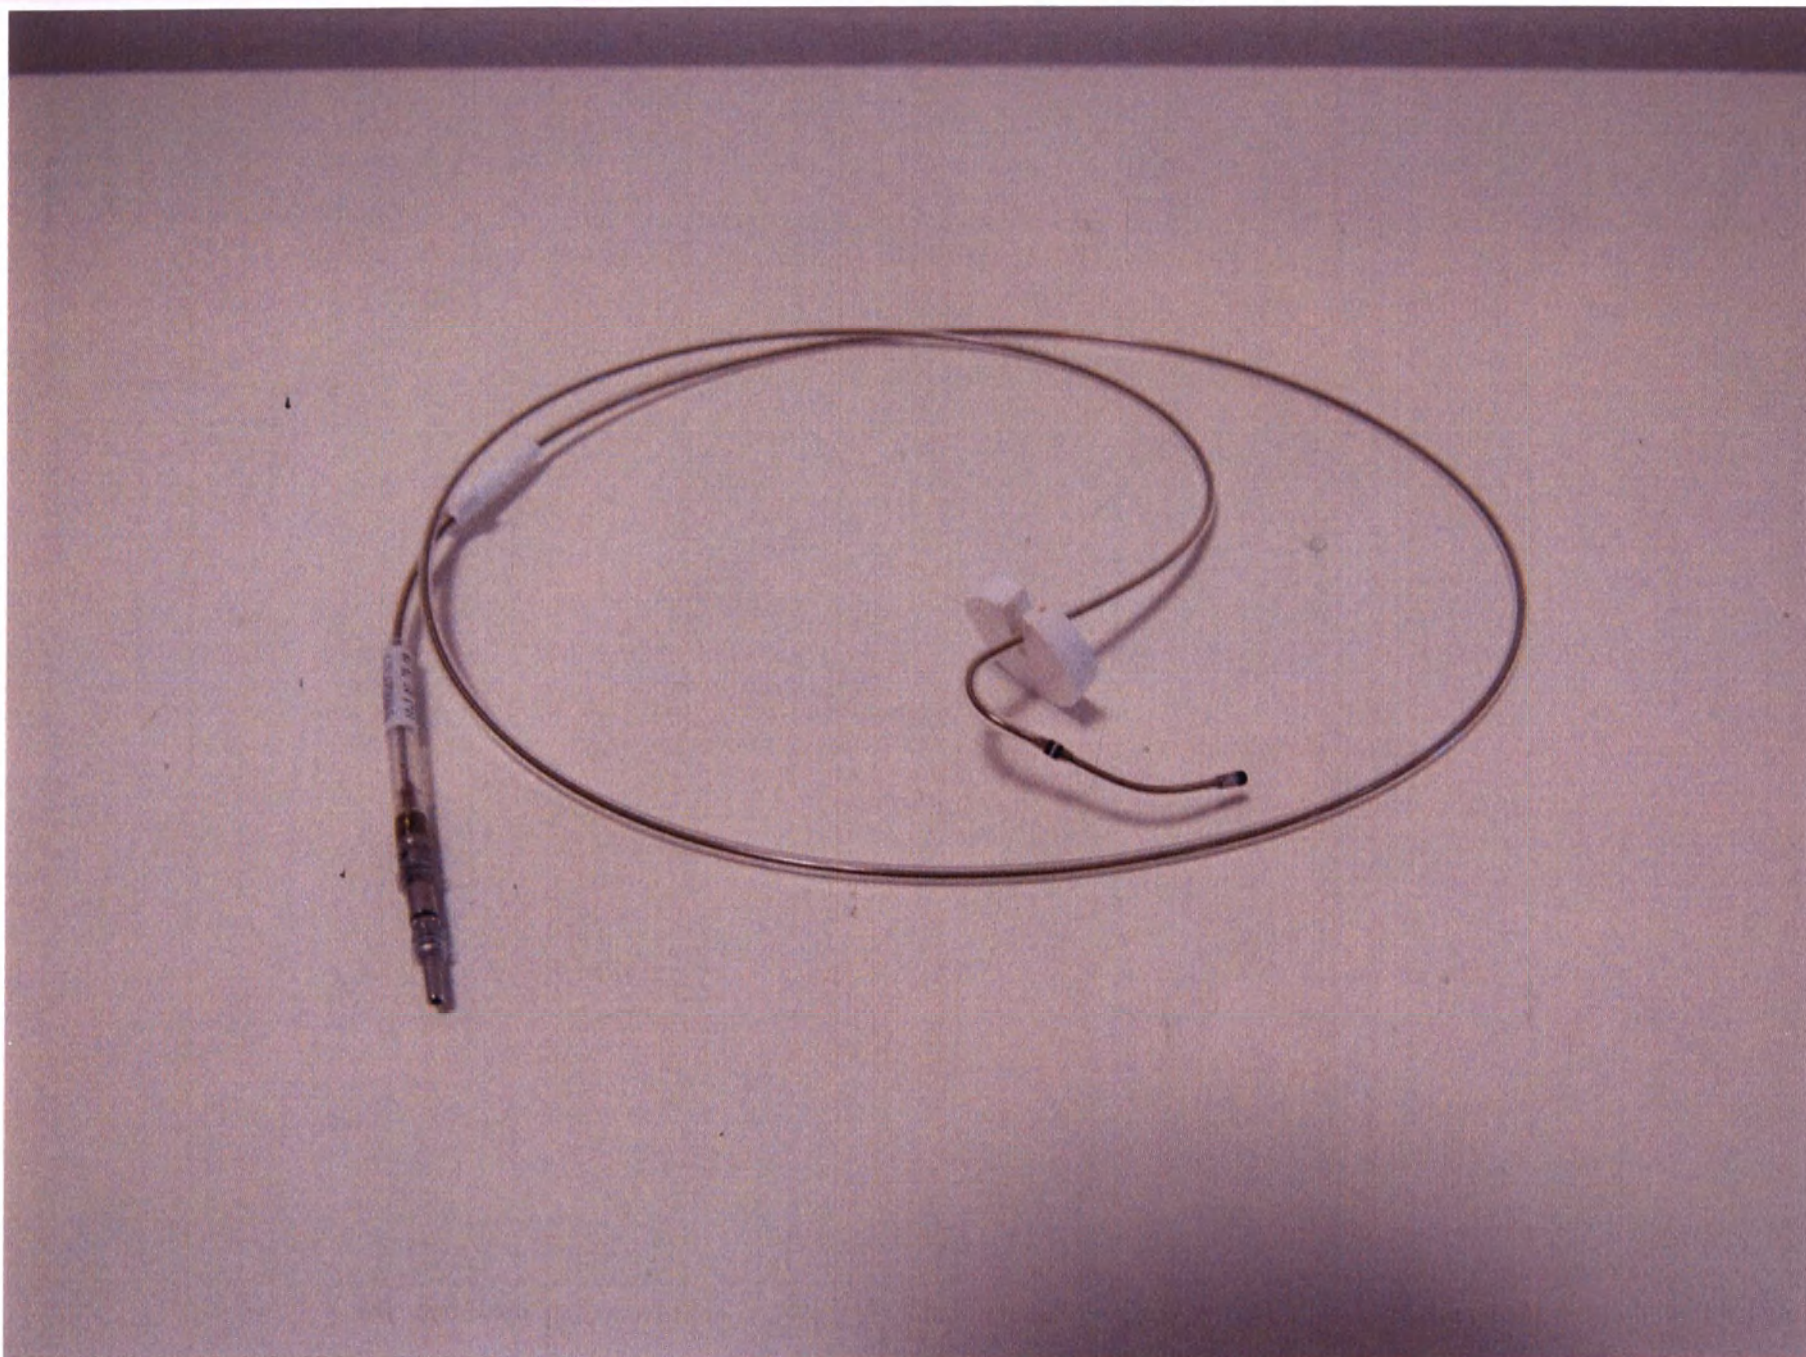


Рисунок 14. Электрод с фиксирующей муфтой

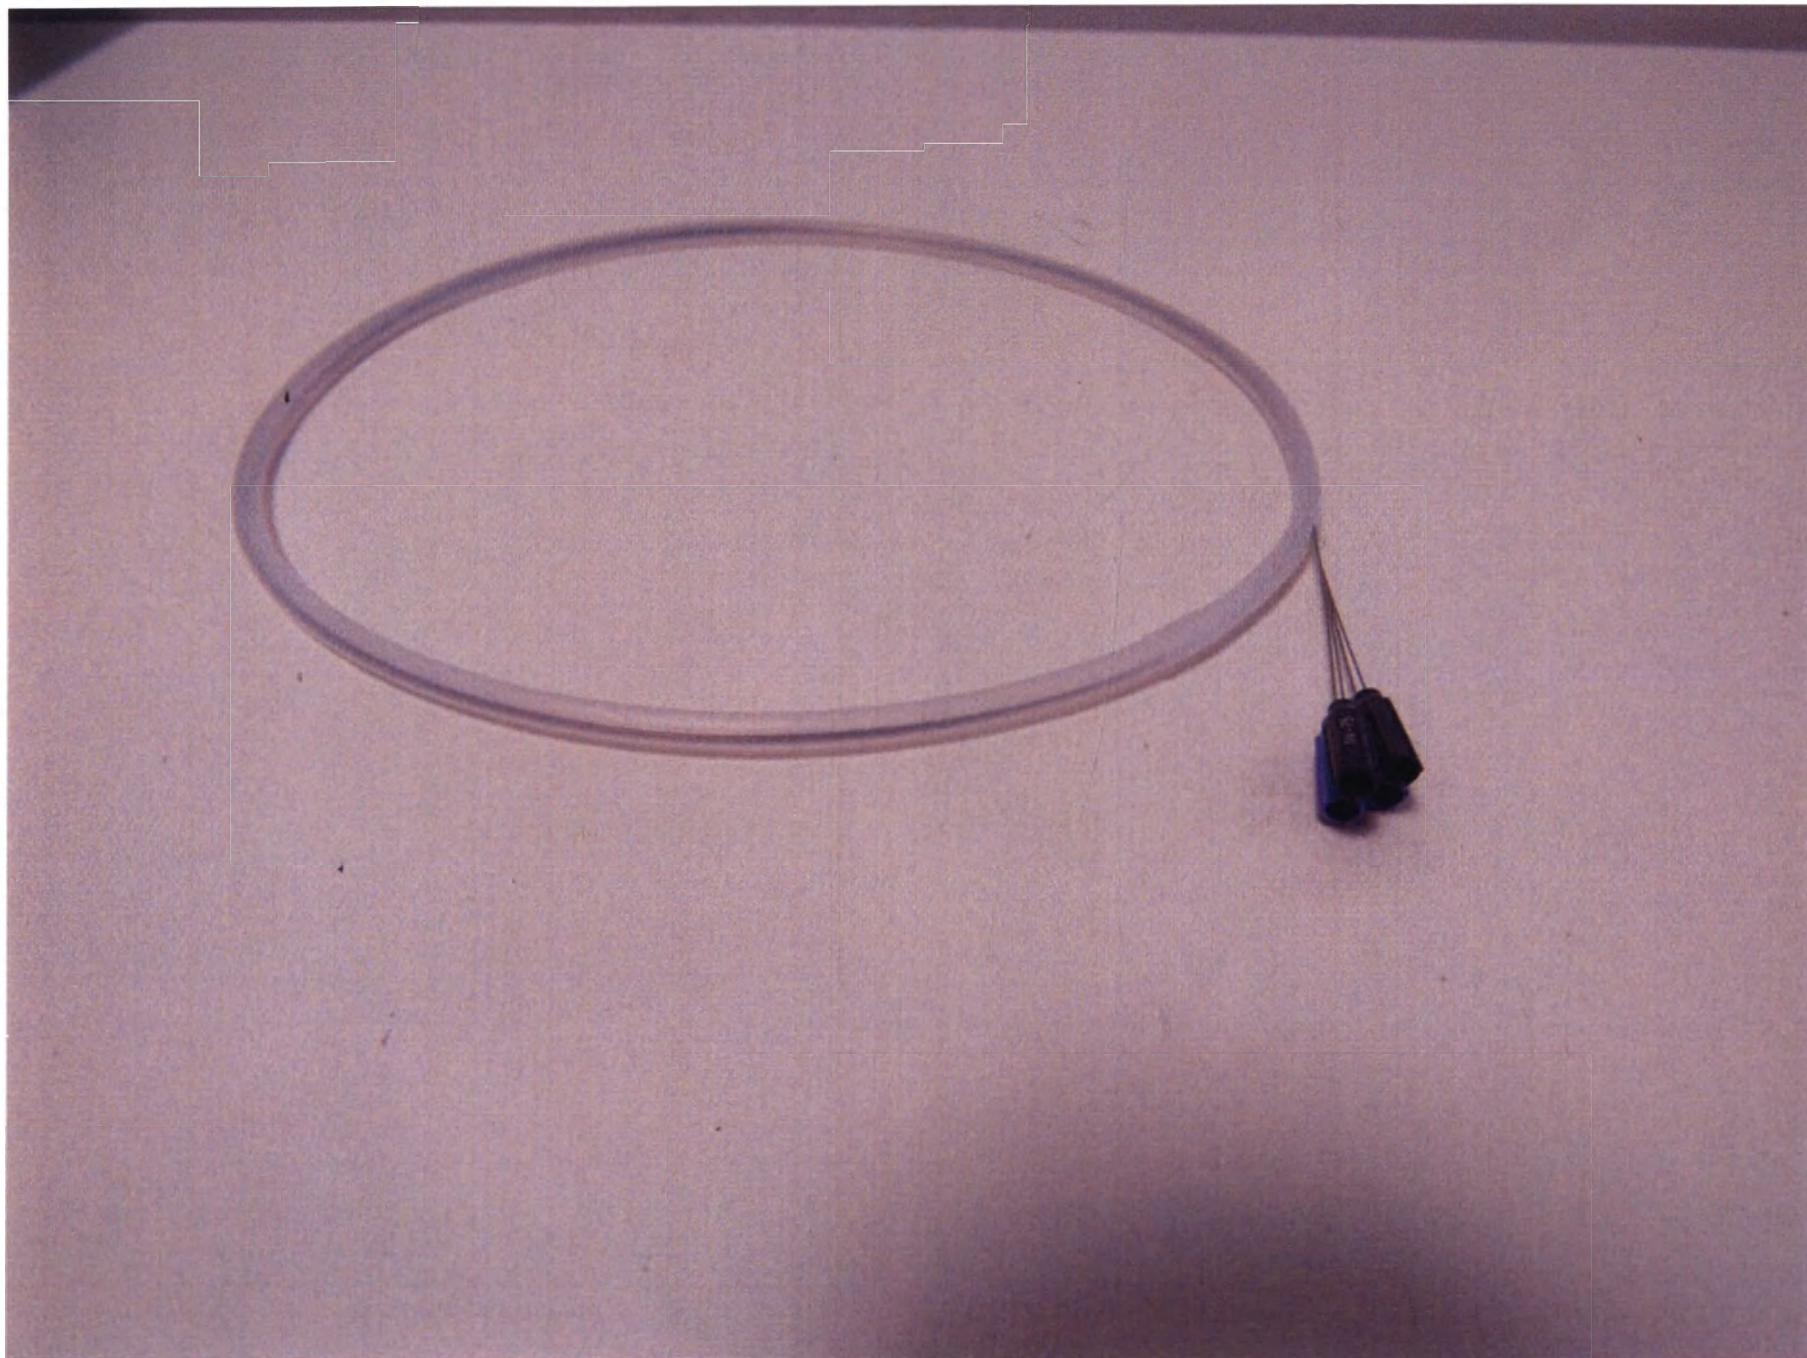


Рисунок 15. Дополнительные стилеты

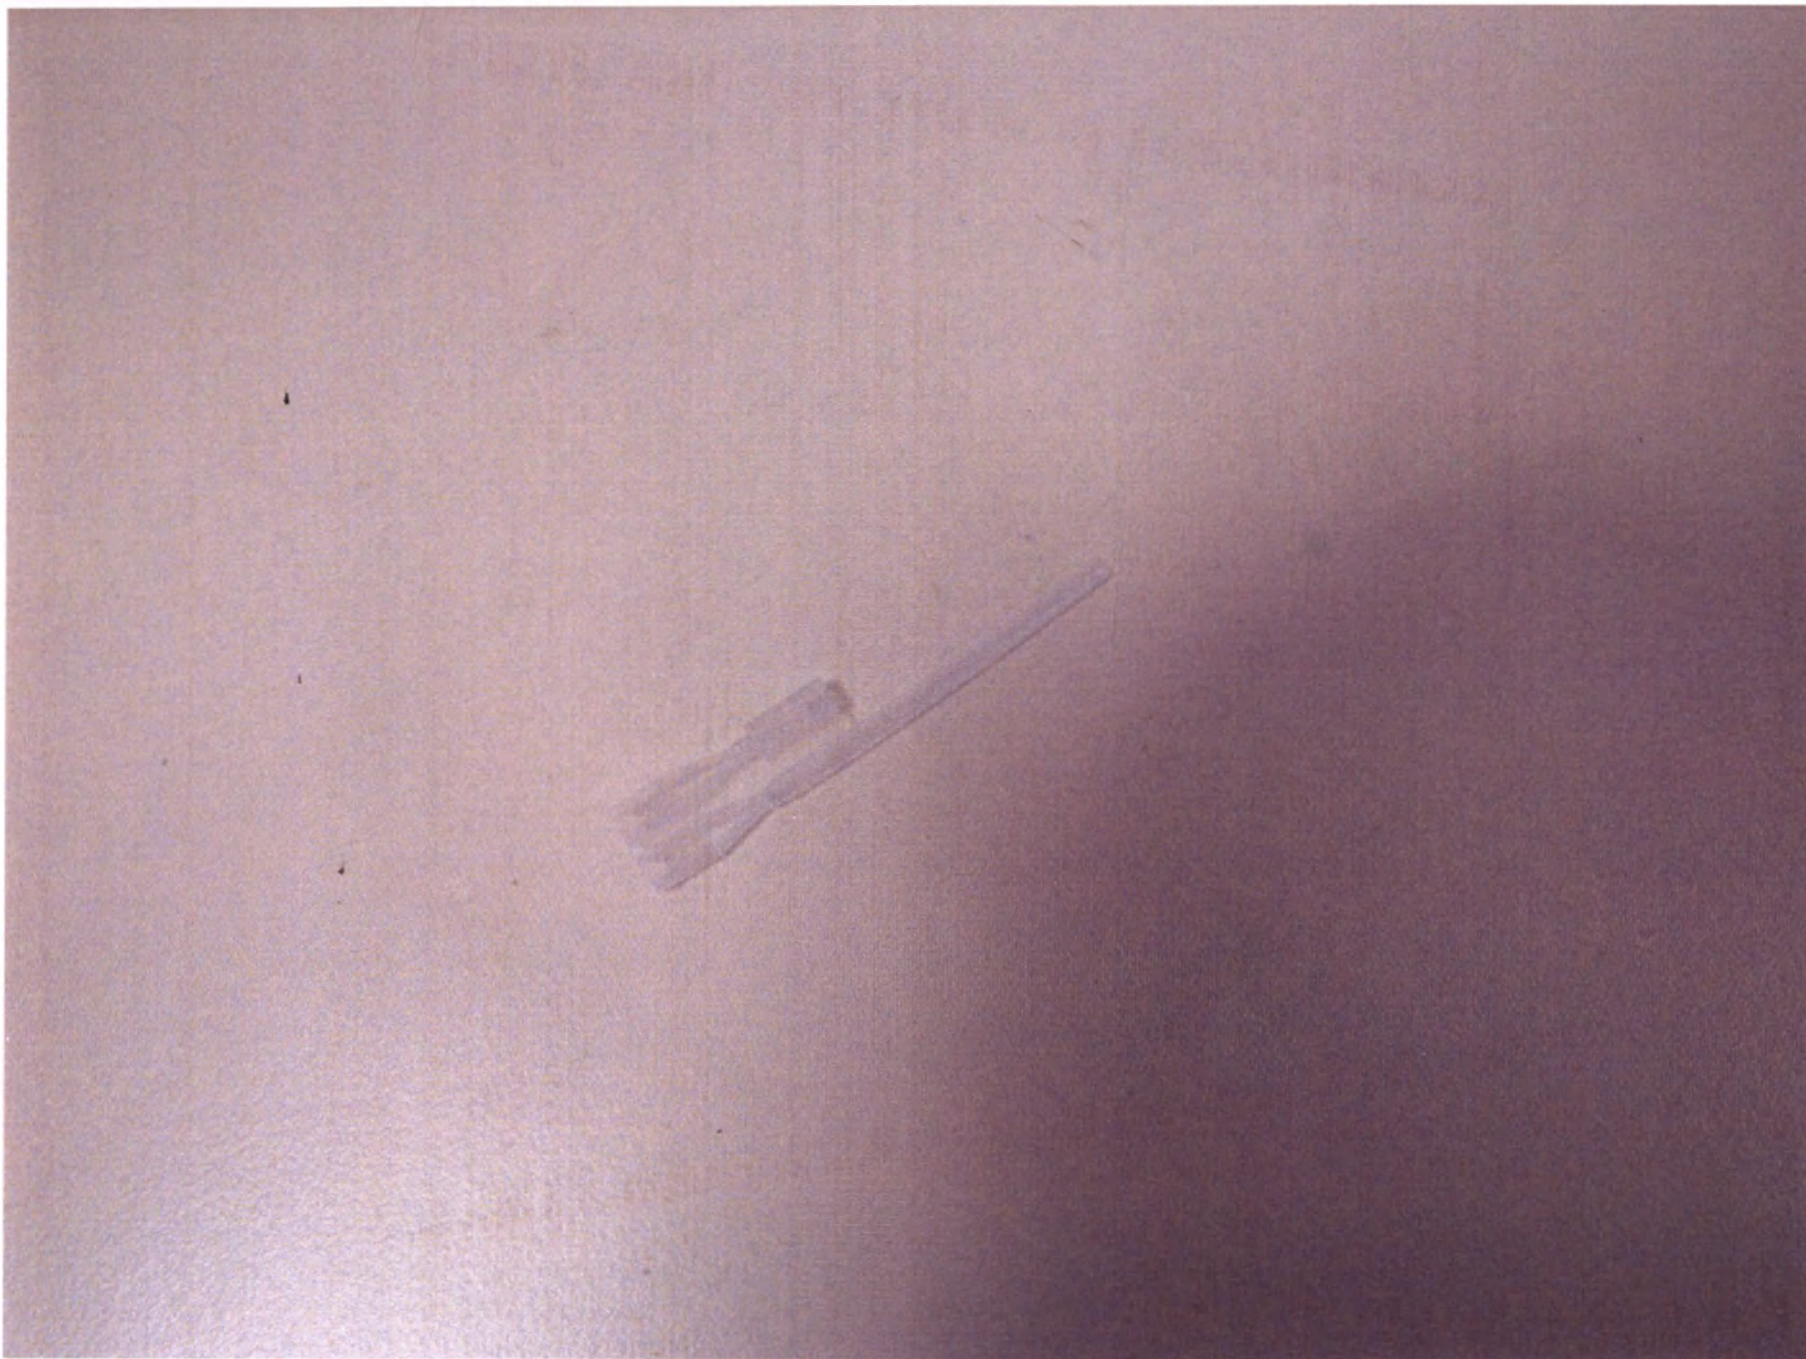


Рисунок 16. Инструмент для введения проволочного проводника

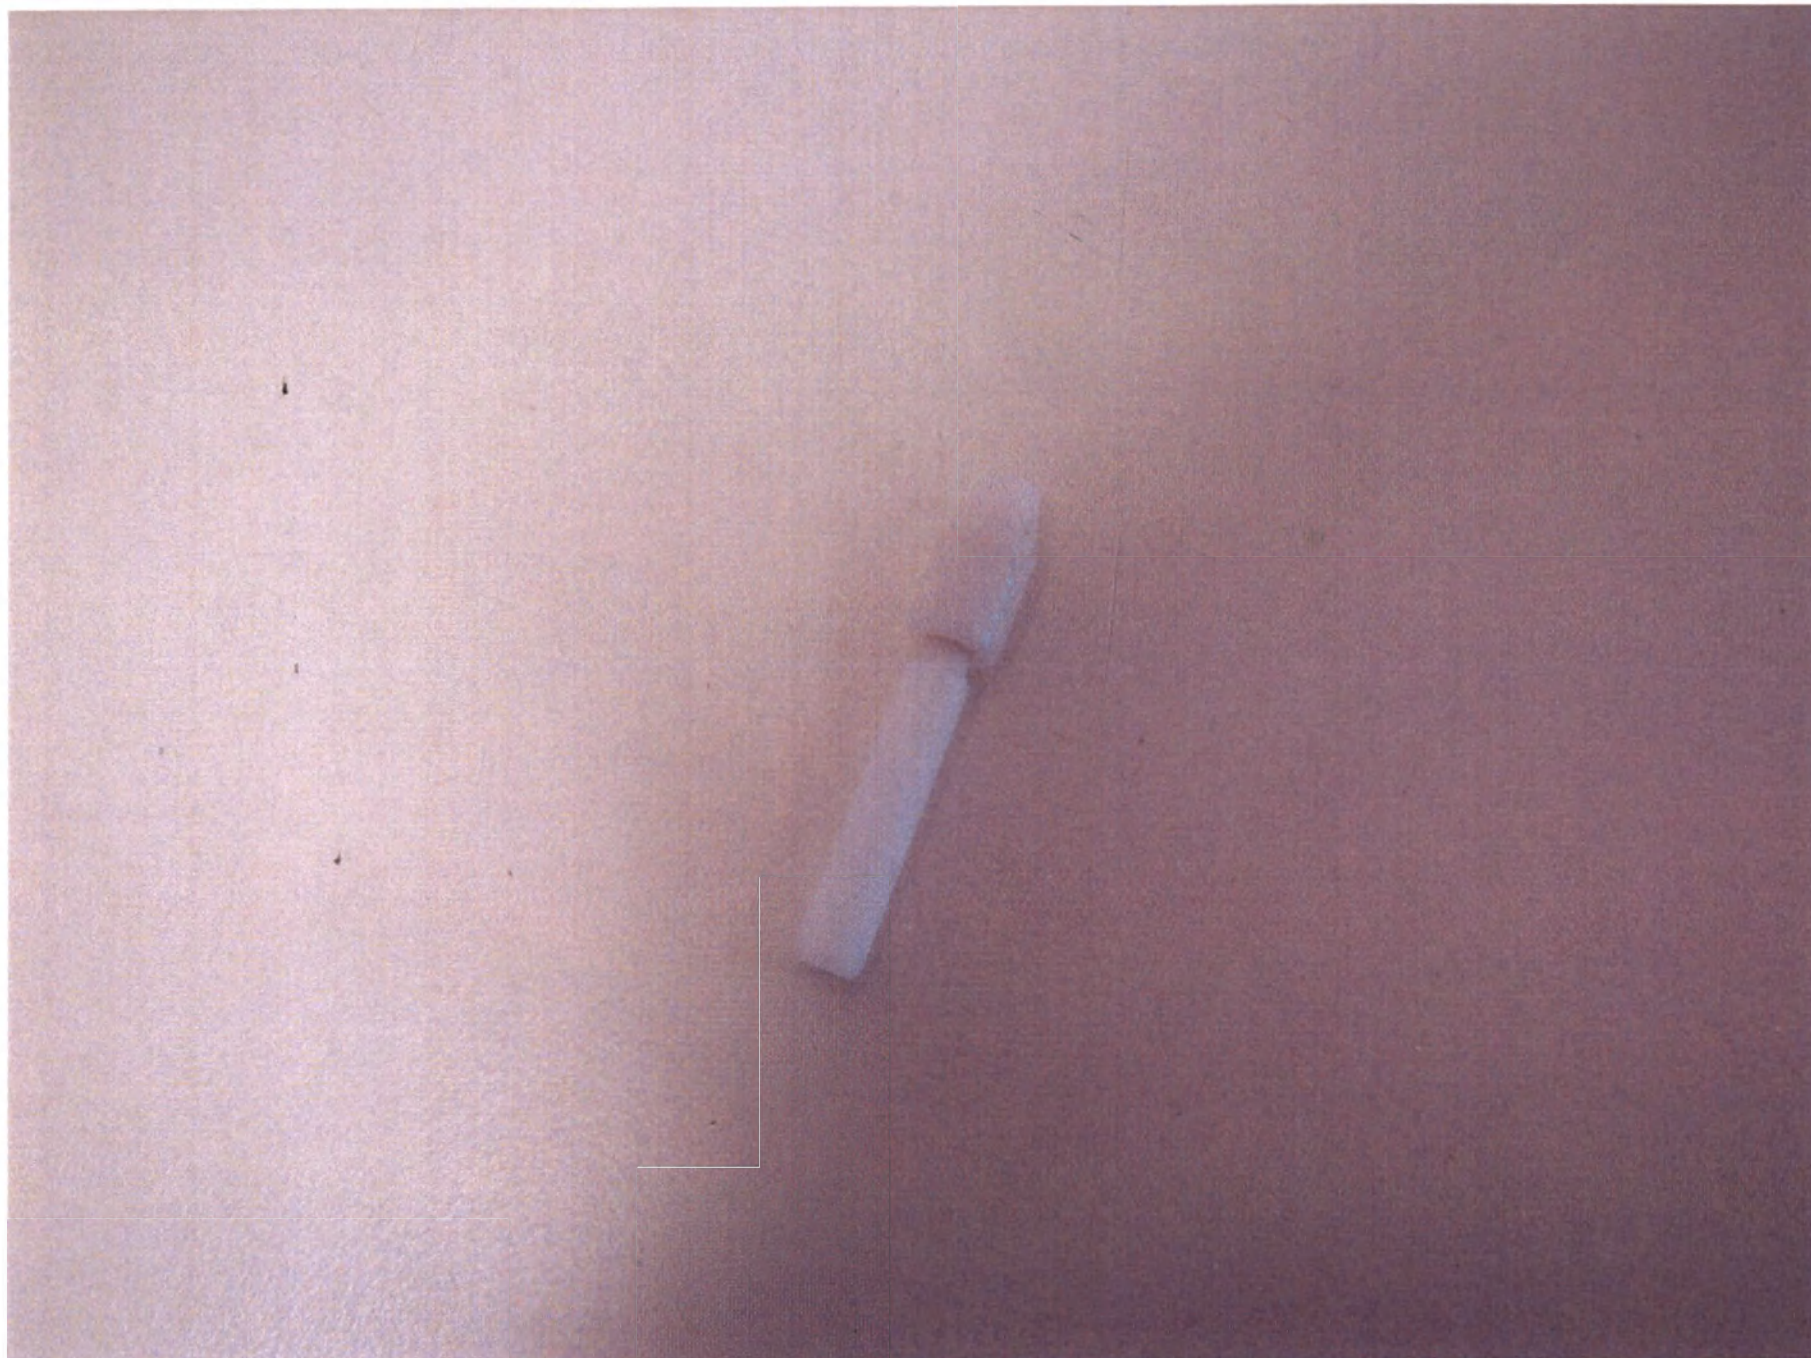


Рисунок 17. Рукоятка управления проволочным проводником

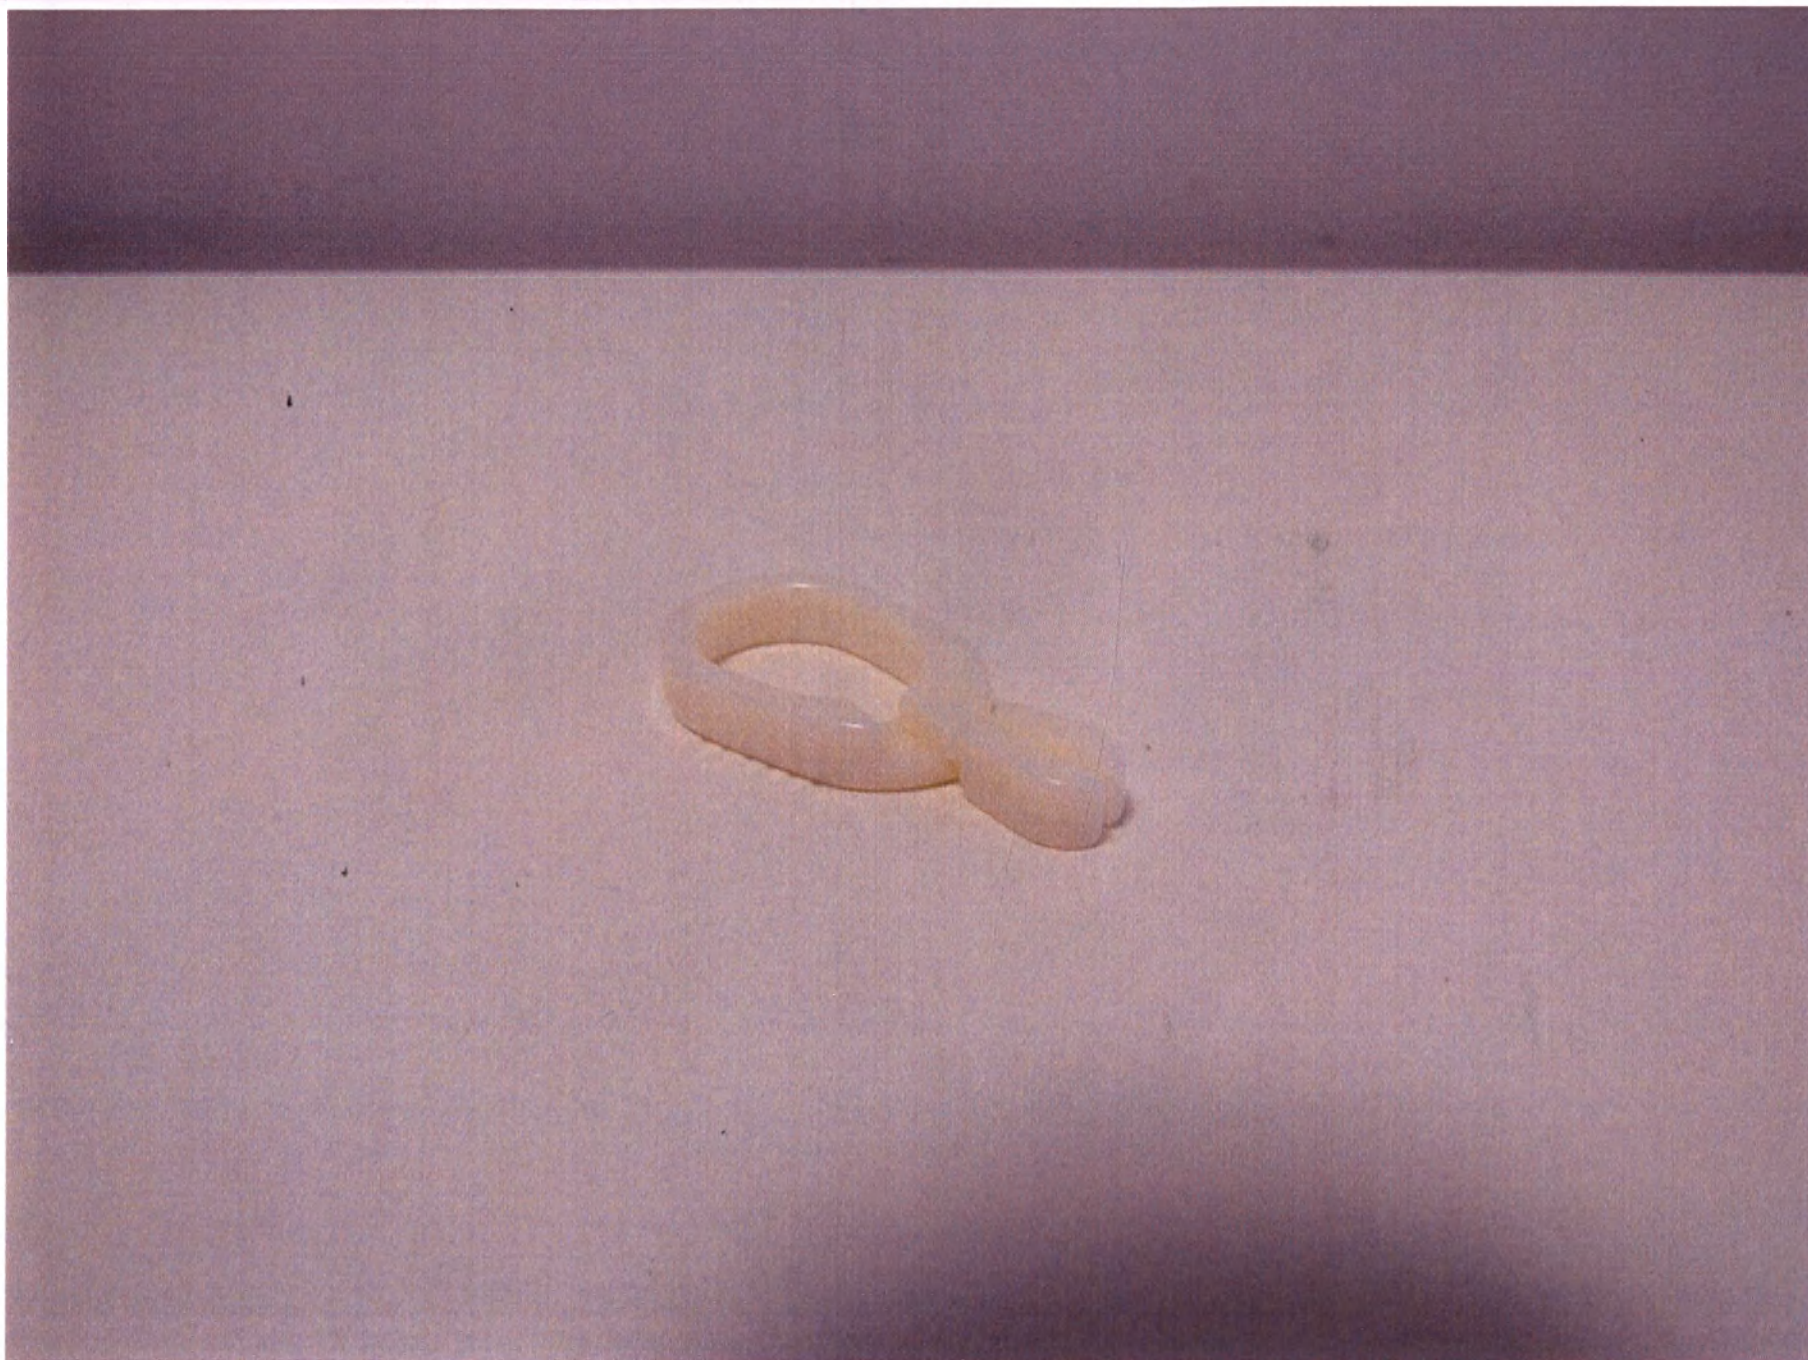


Рисунок 18. Зажим проволочного проводника

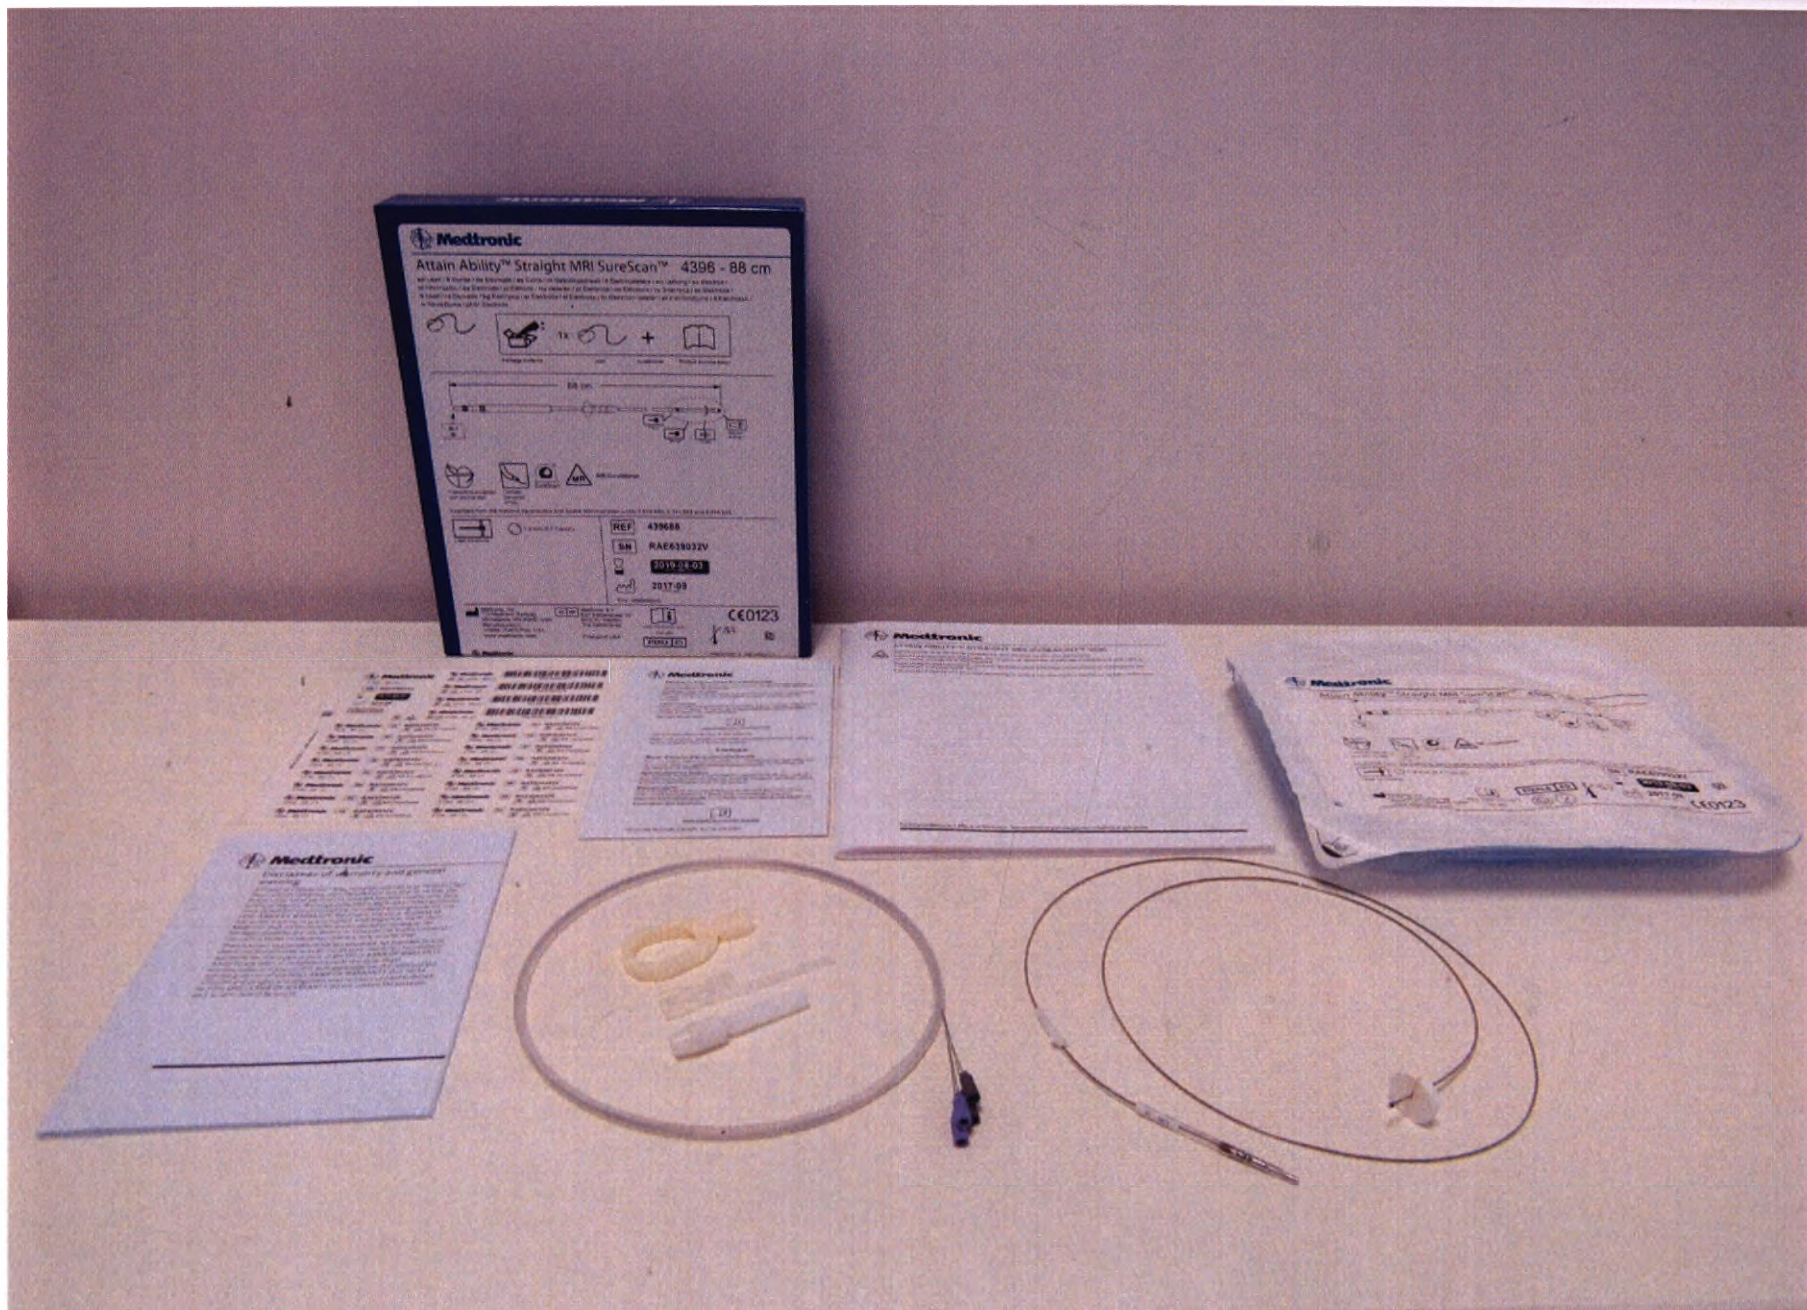


Рисунок 19. Общий вид: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Straight MRI SureScan, модель 4396, длина: 88 см, в составе: электрод с фиксирующей муфтой; инструмент для введения проволочного проводника; зажим проволочного проводника; рукоятка управления проволочным проводником; дополнительные стилеты – до 6 шт.; документация по продукту.



Рисунок 20. Стерильная упаковка: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Straight MRI SureScan, модель 4396, длина: 88 см

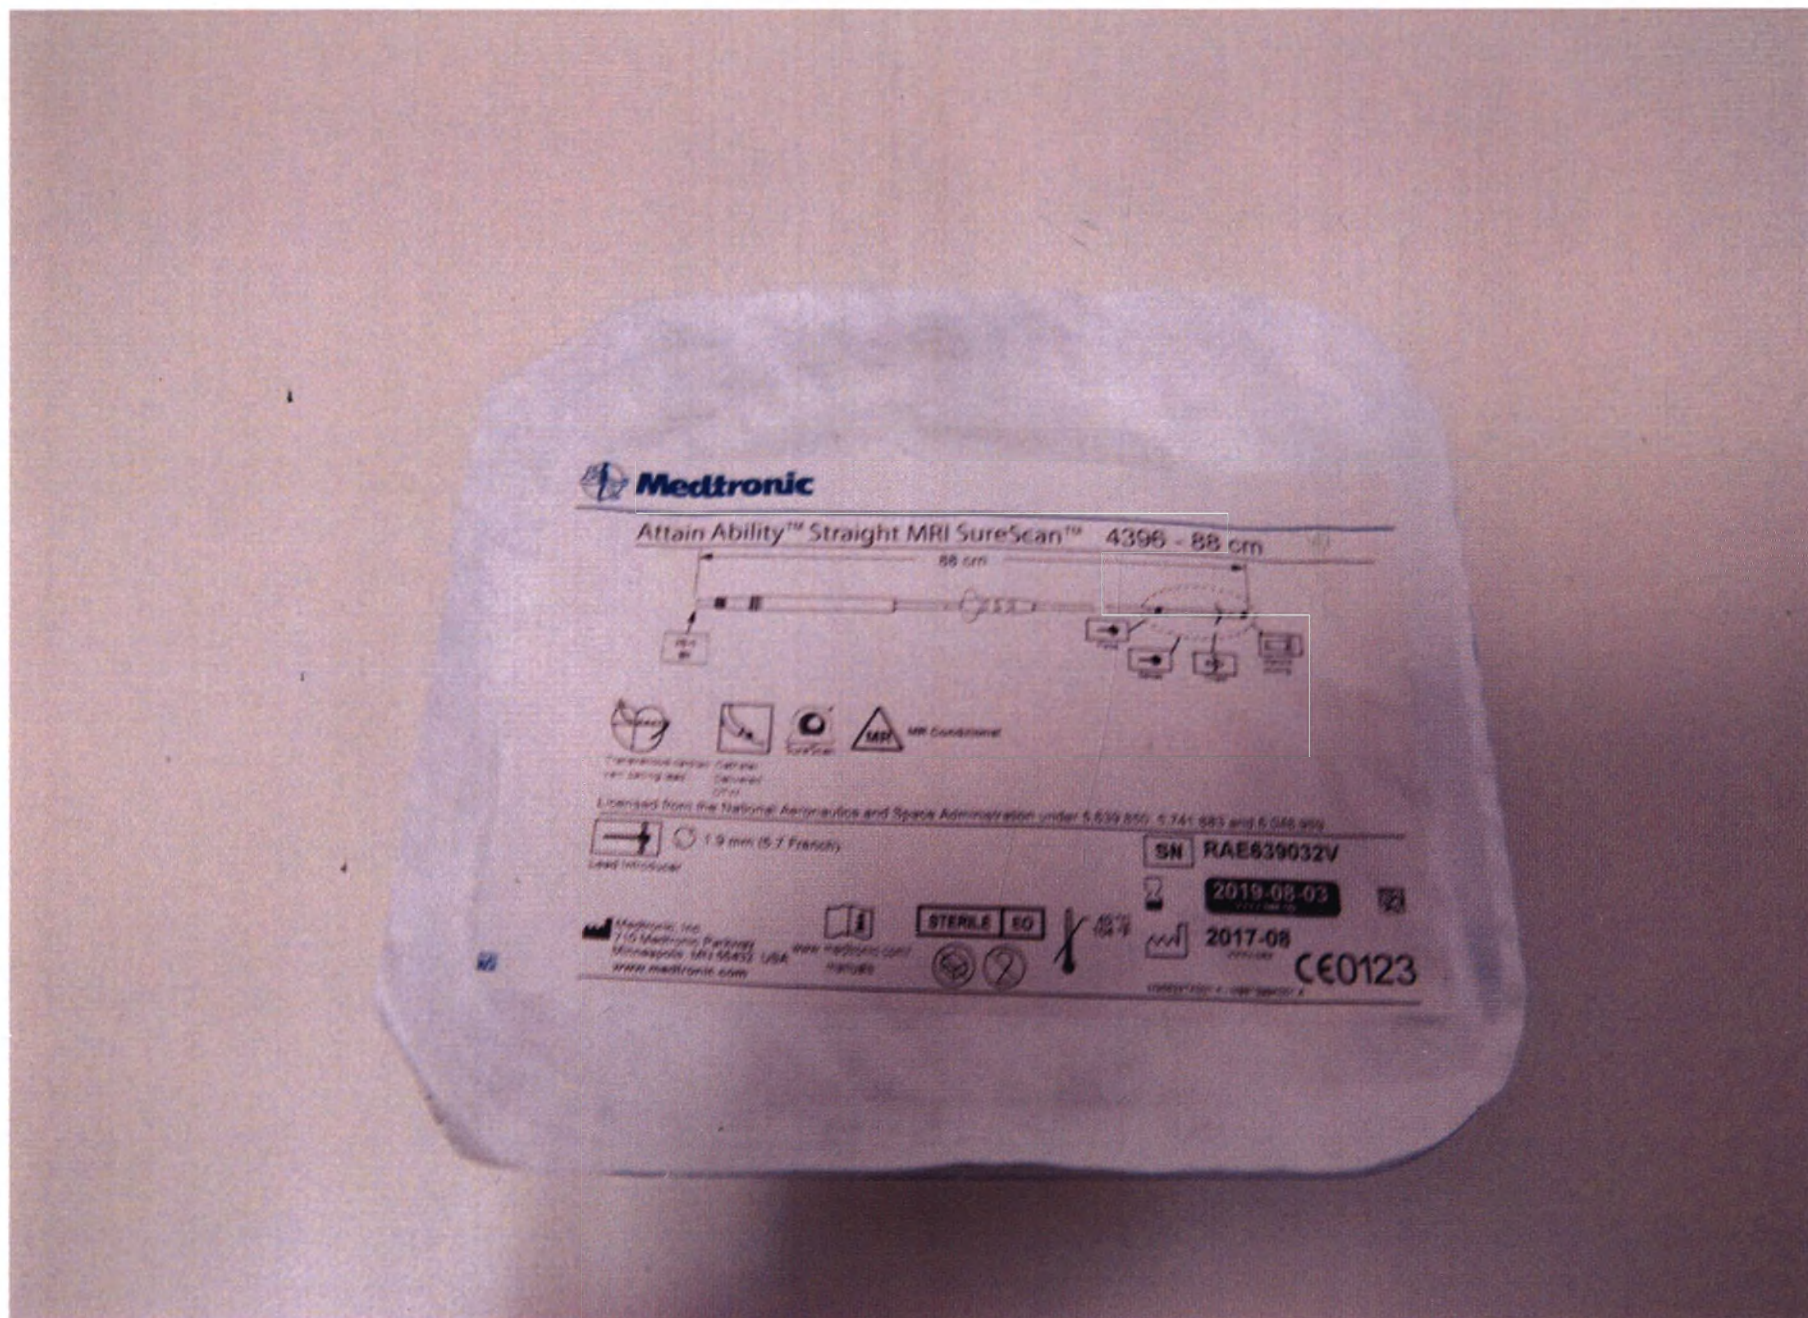


Рисунок 21. Маркировка стерильной упаковки: Электрод для стимуляции в кардиальной вене Attain Ability Straight MRI SureScan, модель 4396, длина: 88 см

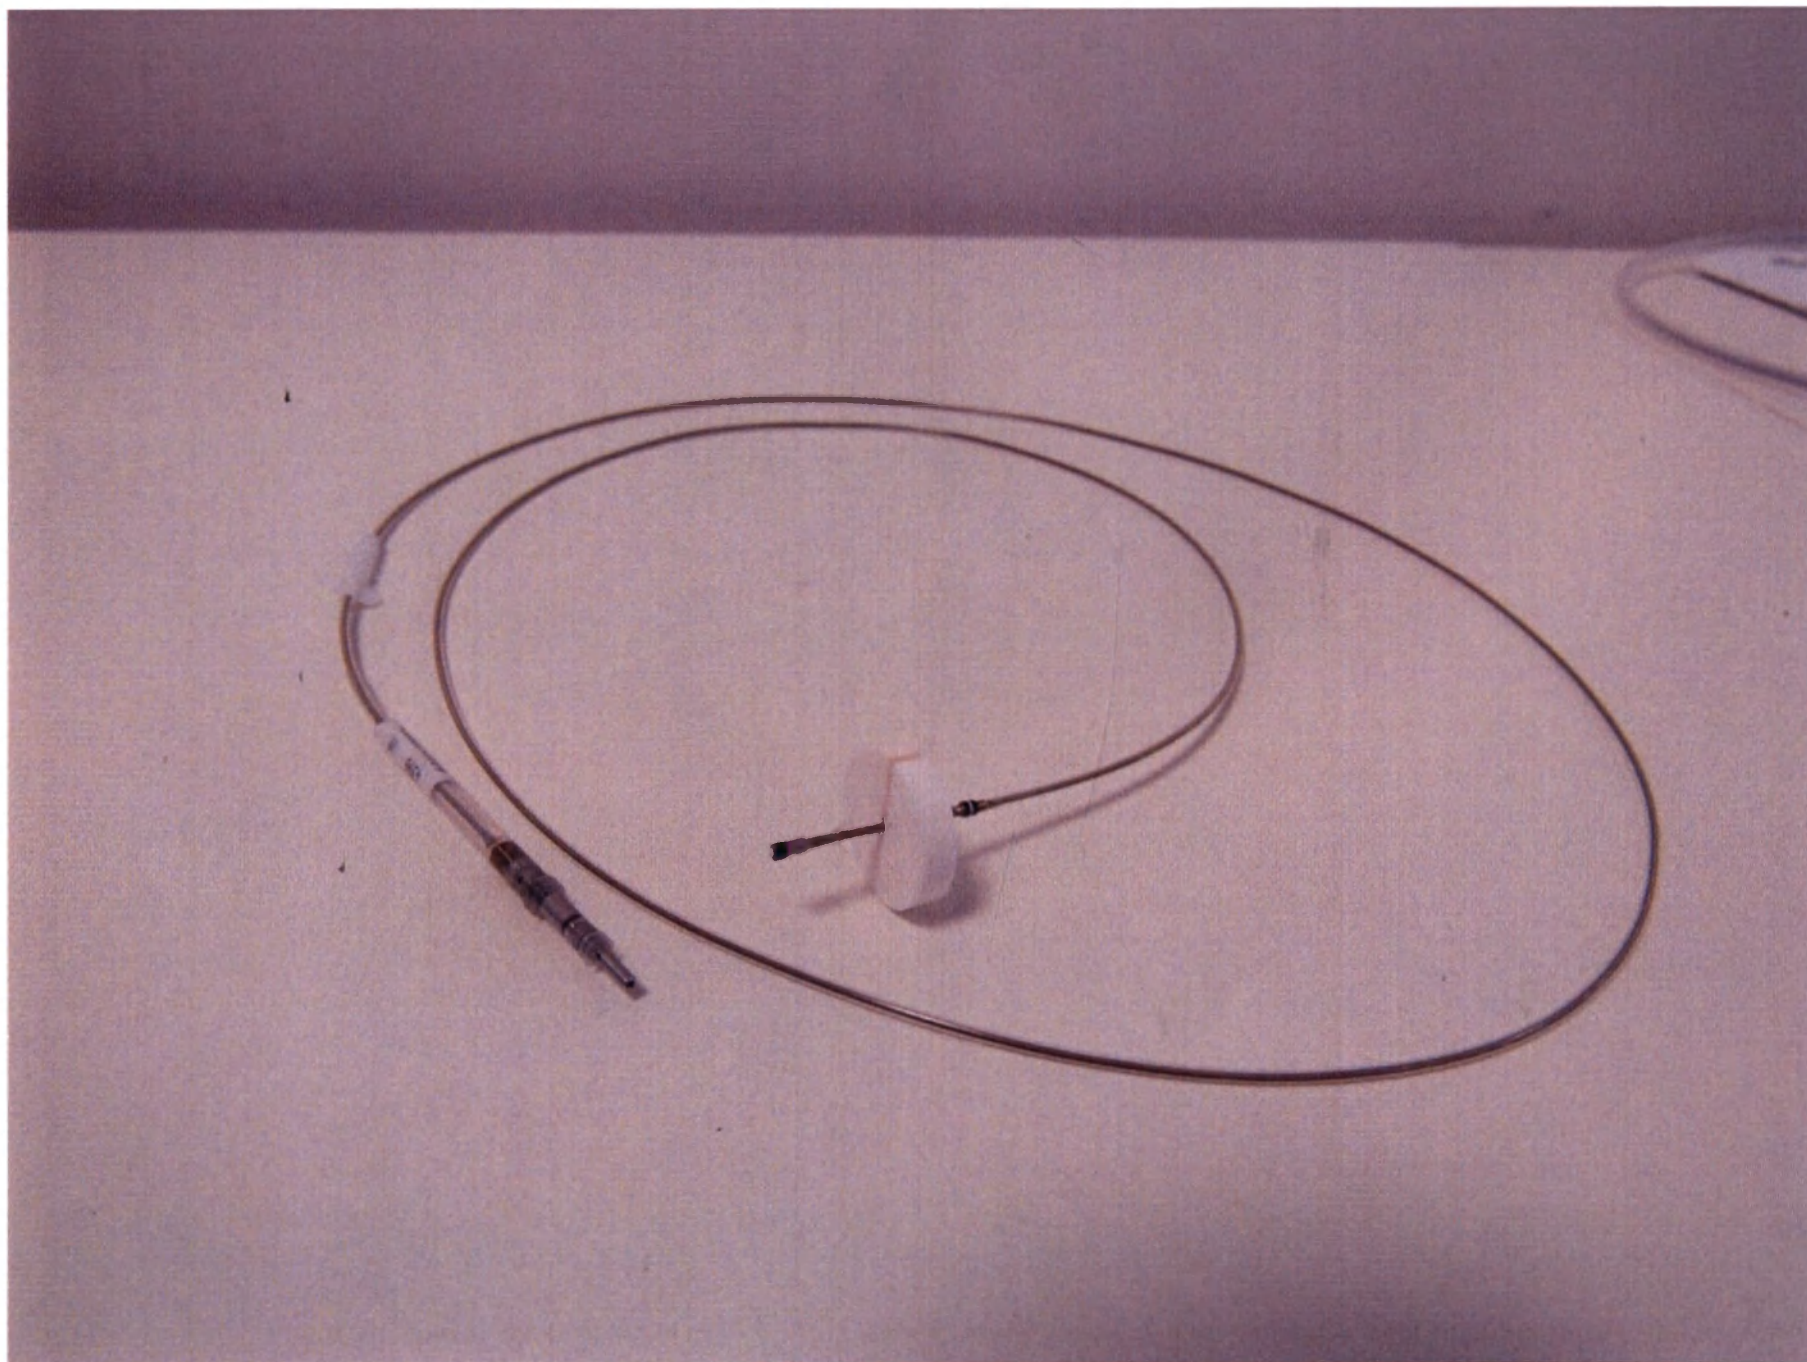


Рисунок 23. Электрод с фиксирующей муфтой

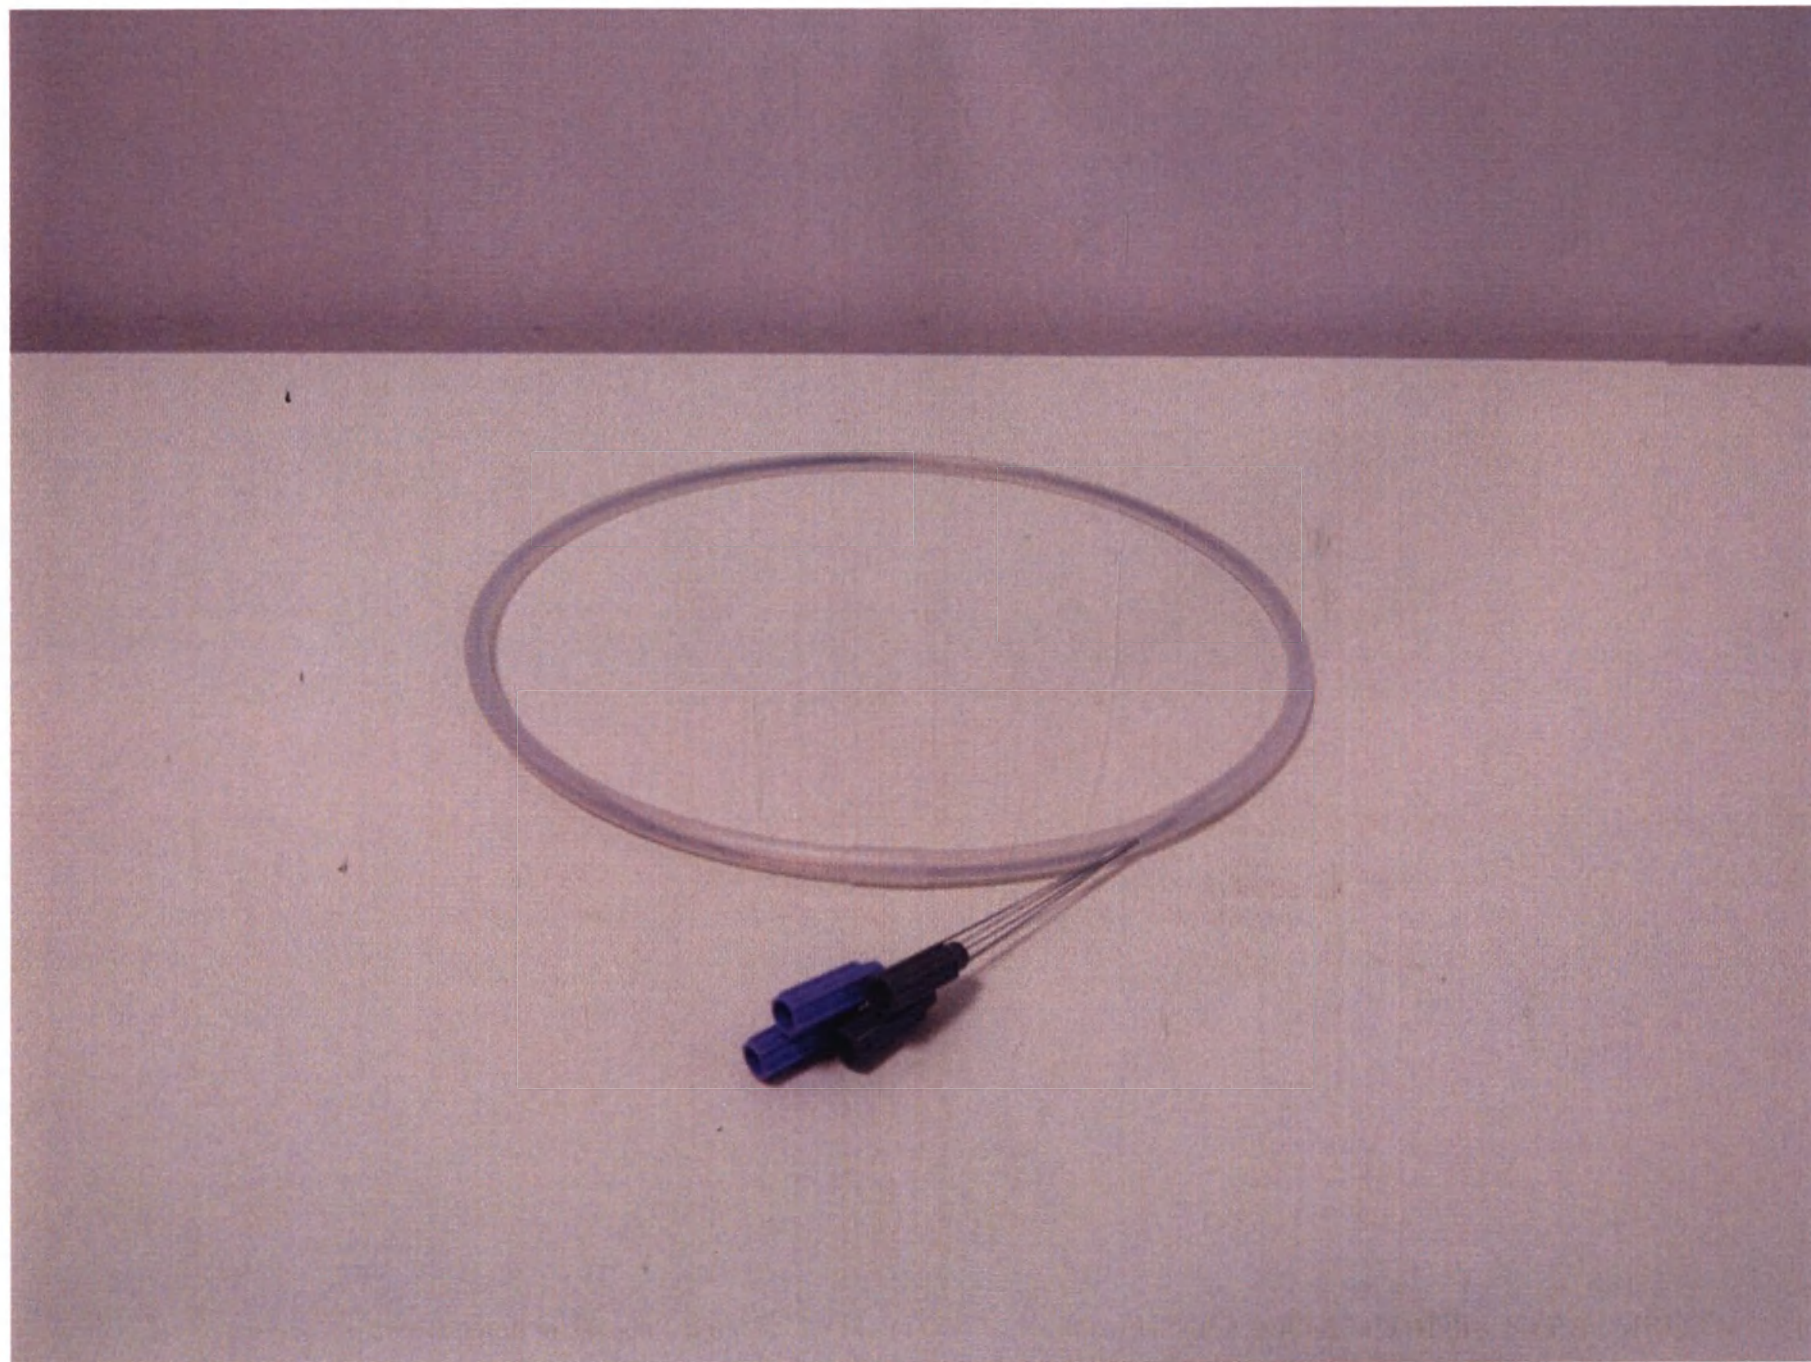


Рисунок 24. Дополнительные стилеты

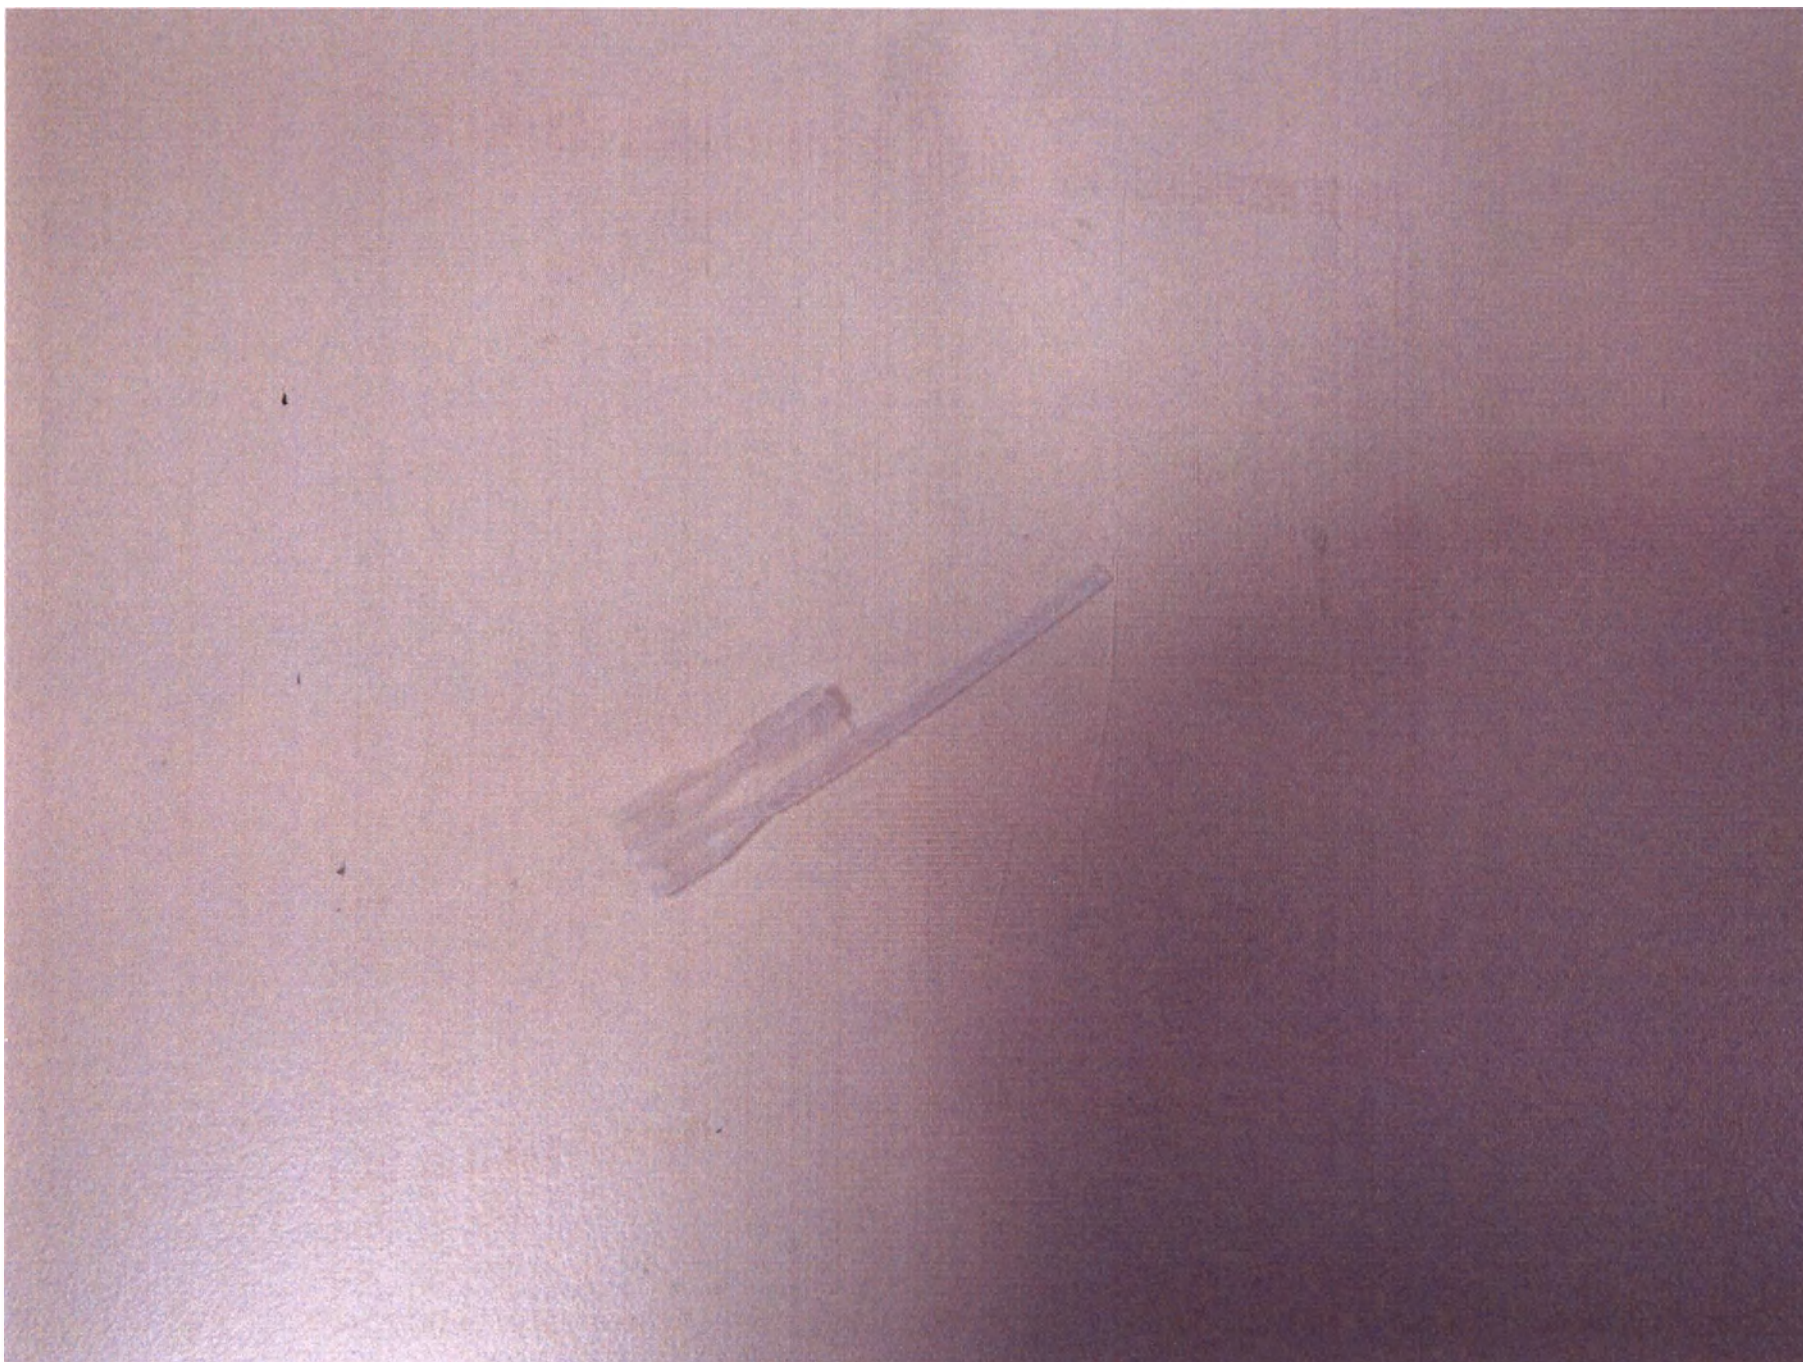


Рисунок 25. Инструмент для введения проволочного проводника

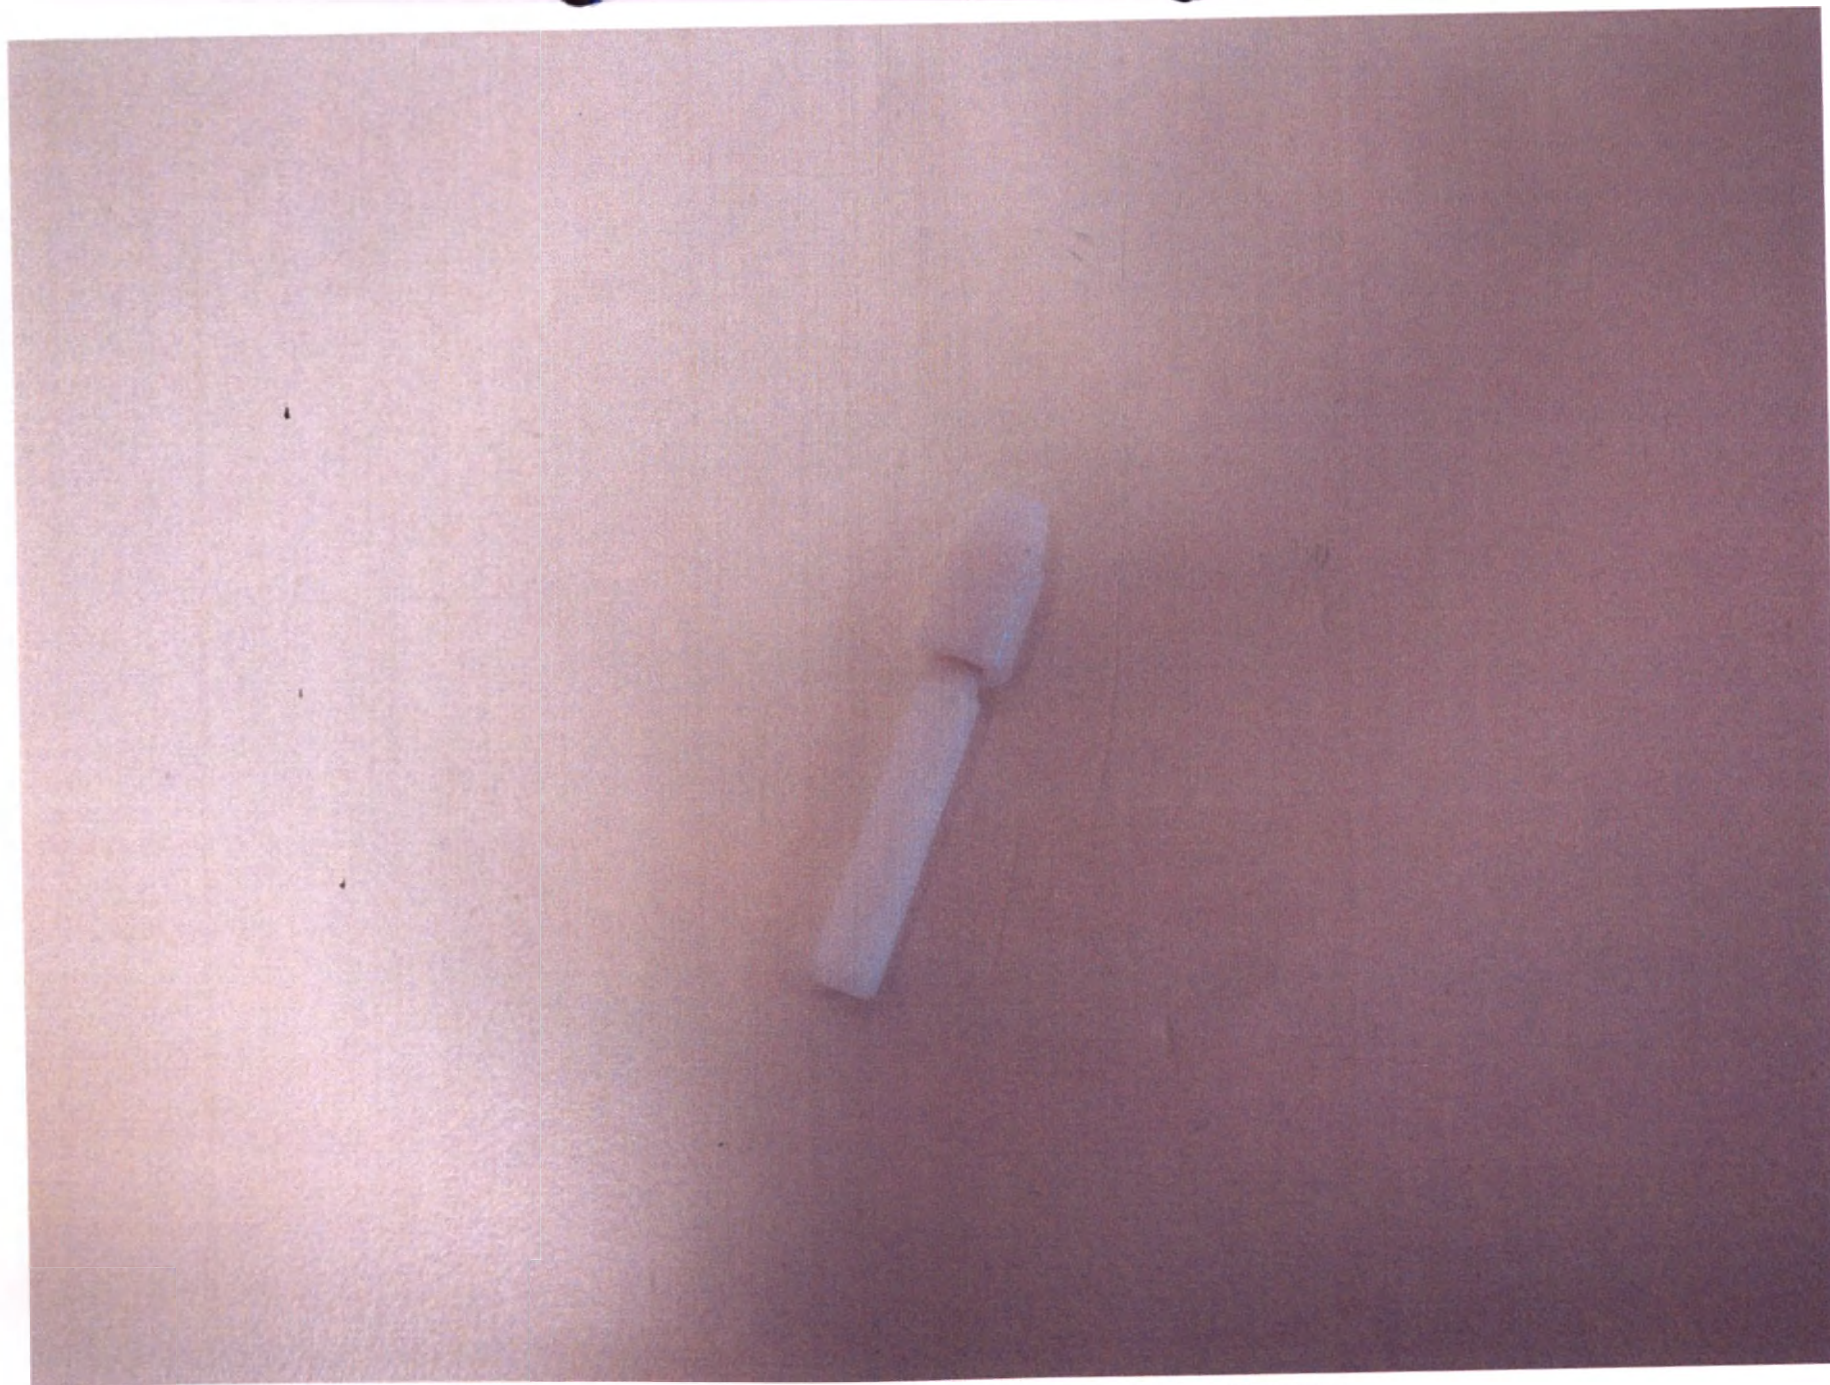


Рисунок 26. Рукоятка управления проволочным проводником

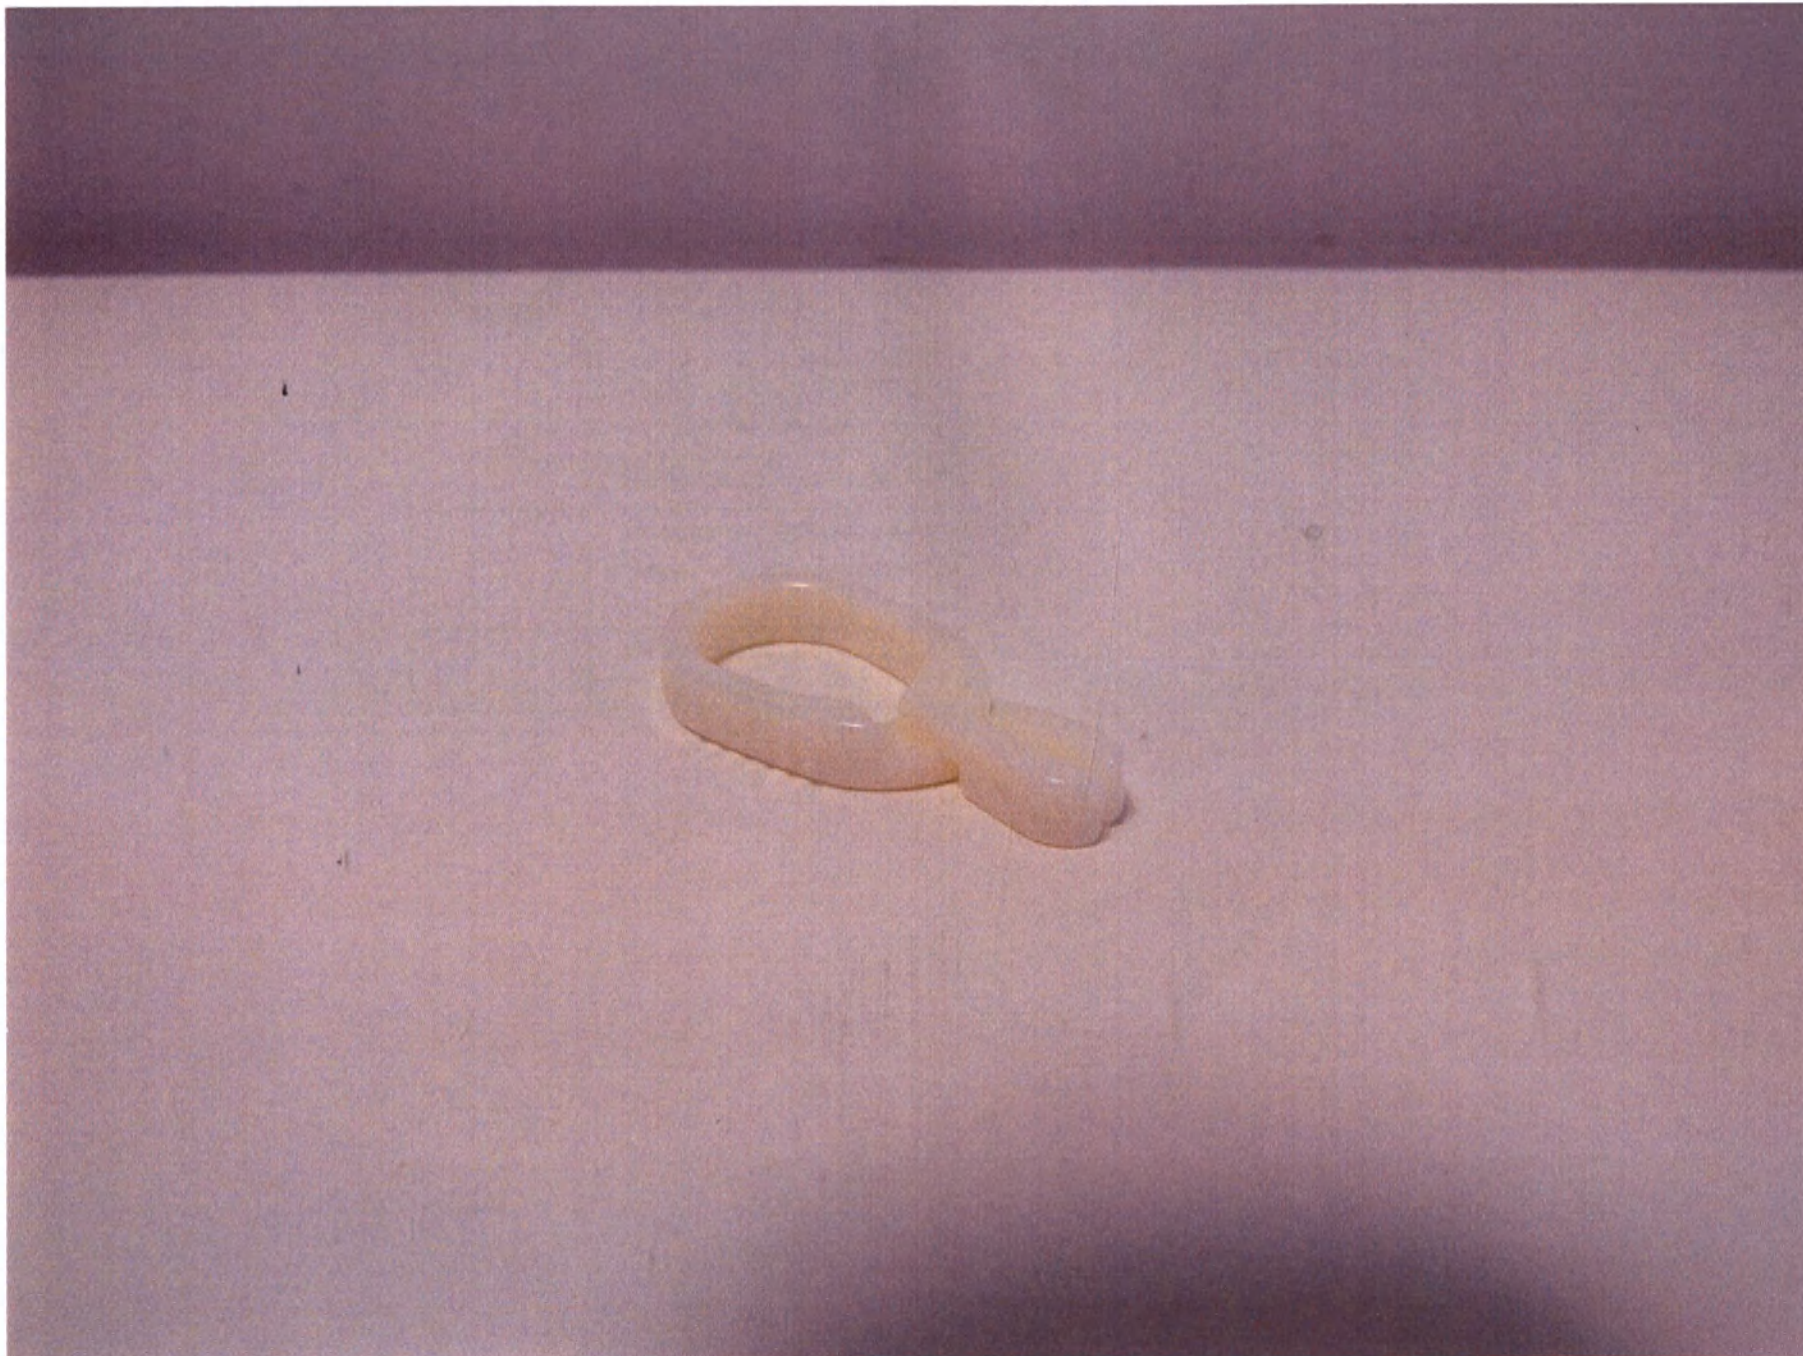


Рисунок 27. Зажим проволочного проводника

Образец локальной маркировки медицинского изделия

	Наименование медицинского изделия	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное удостоверение № ____ от ____	
	Дата изготовления. / серийный номер / использовать до: см. на упаковке	См. инструкции См. символы на упаковке
	Не токсично Апирогенно	

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"

29 листа(ов)

