

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУМЭКС Медикал»



Н.В. Макарова

«18» июня 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор офтальмологический SmartJect для имплантации интраокулярных линз, в вариантах исполнения SmartJect 2.8, SmartJect 2.2

Вариант исполнения SmartJect 2.8



Рисунок 1 – Потребительская упаковка, вид спереди

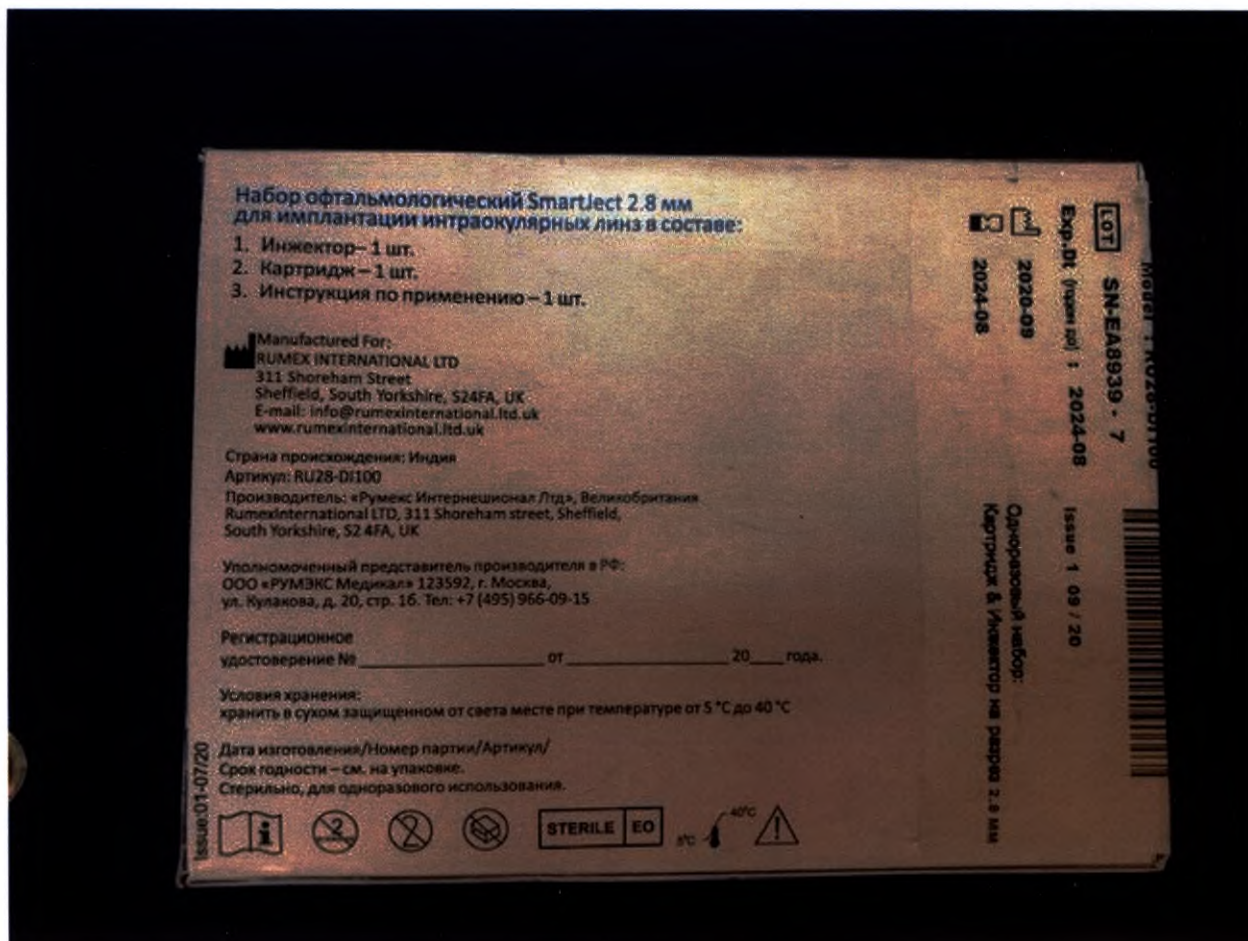


Рисунок 2 – Потребительская упаковка, вид сзади

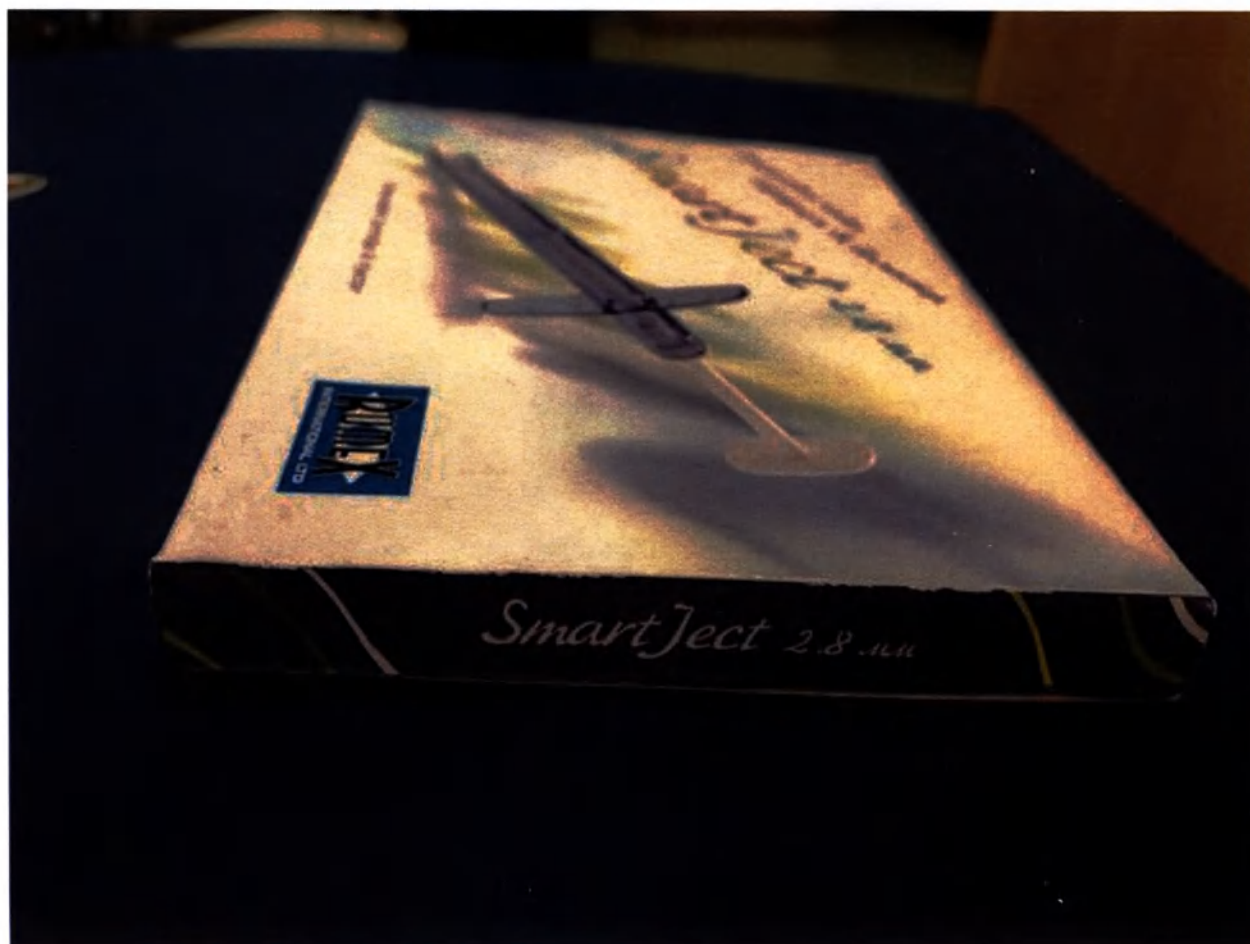


Рисунок 4 – Потребительская упаковка, вид сбоку

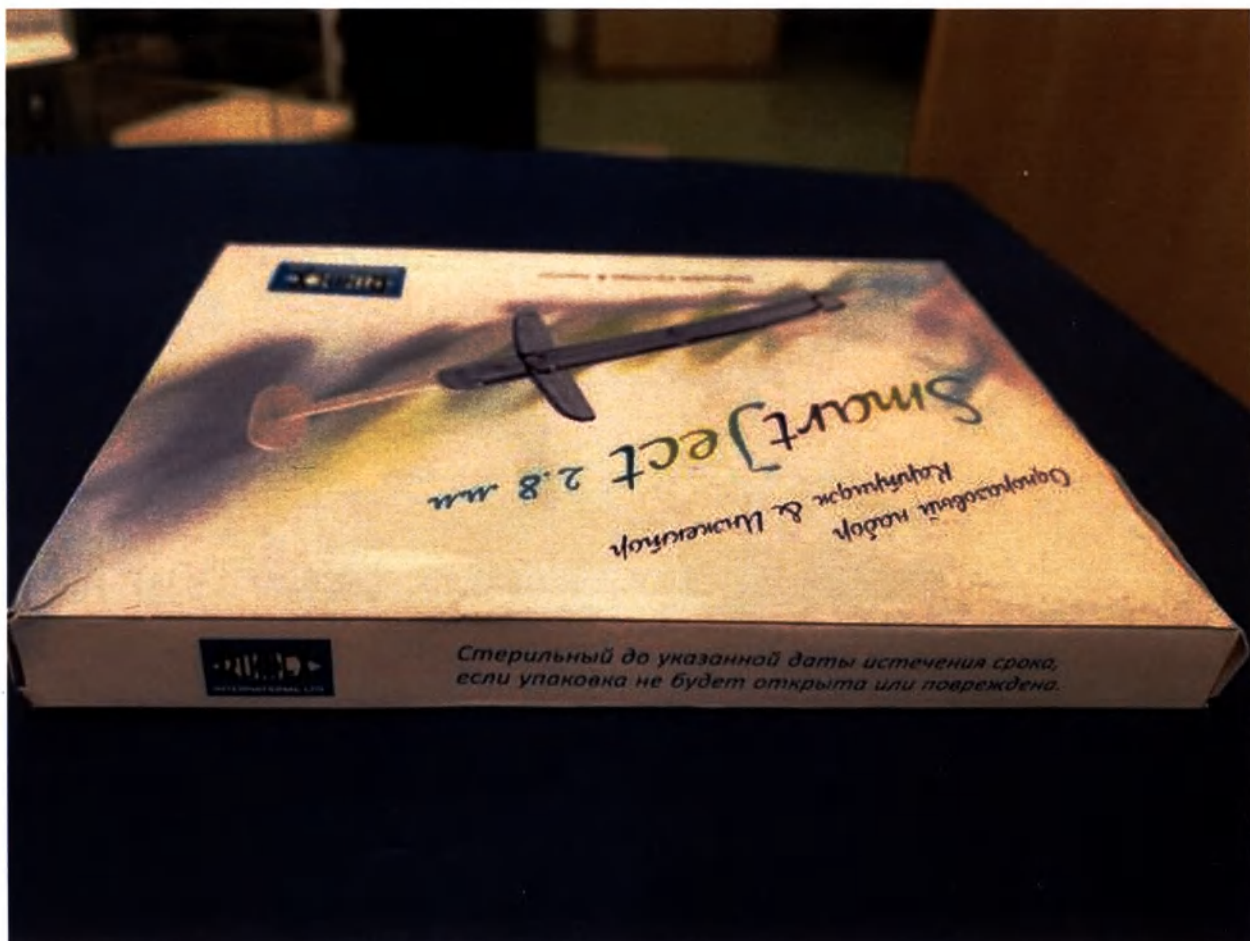


Рисунок 5 – Потребительская упаковка, вид сверху

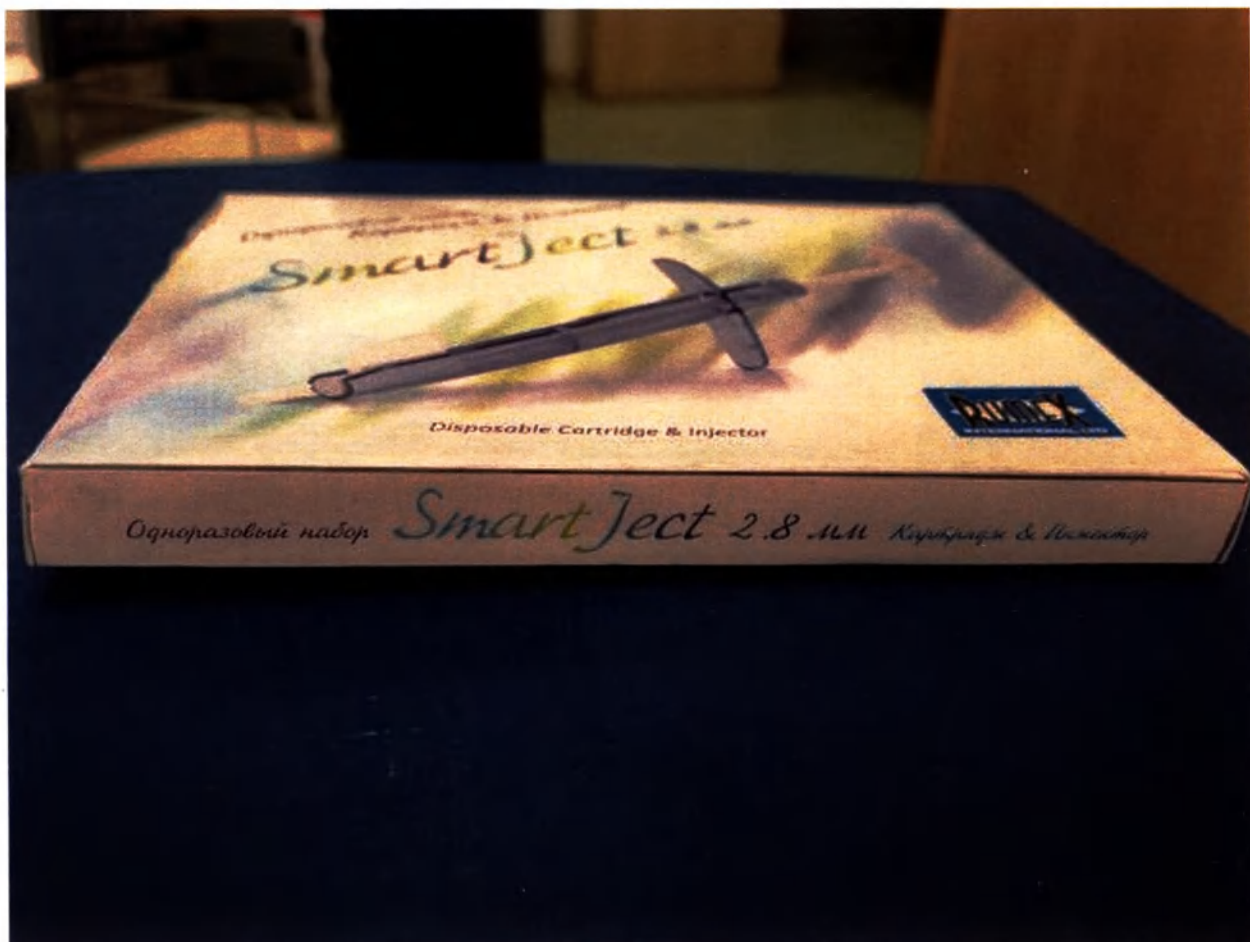


Рисунок 6 – Потребительская упаковка, вид снизу

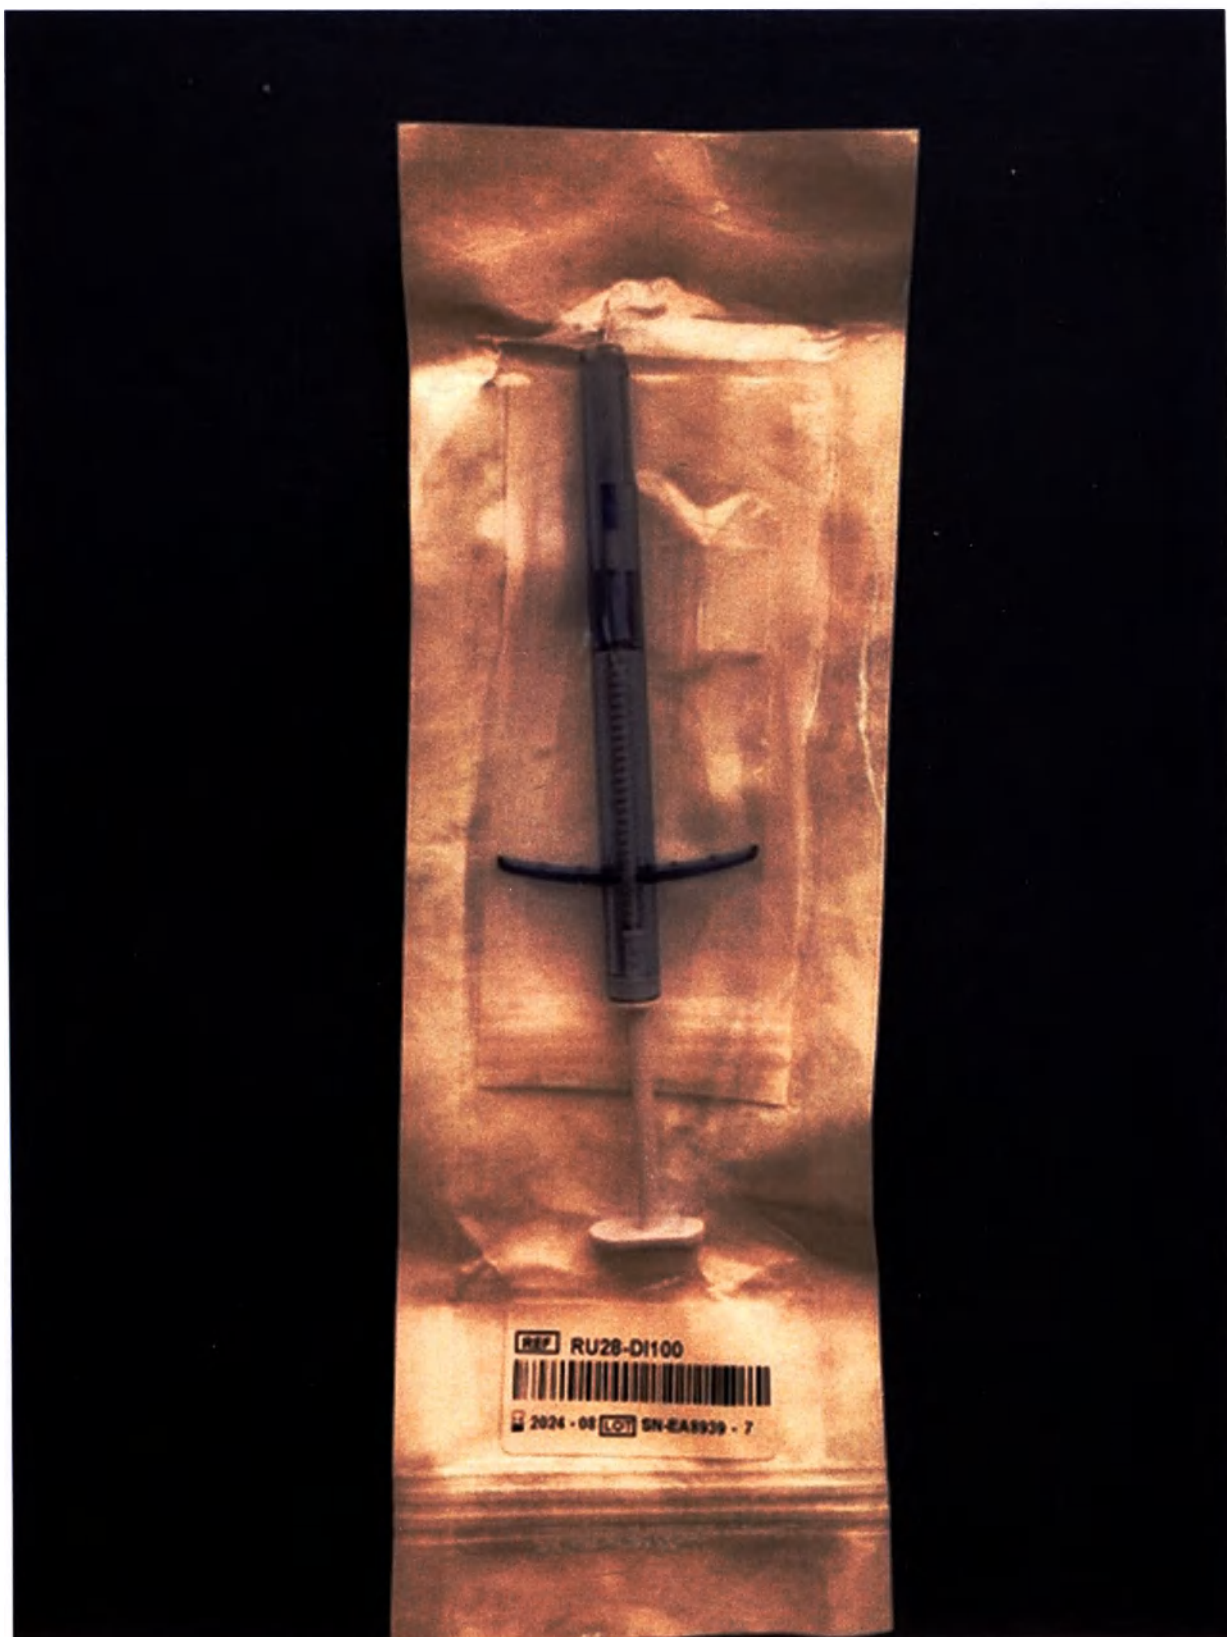


Рисунок 7 – Инжектор в индивидуальной упаковке.

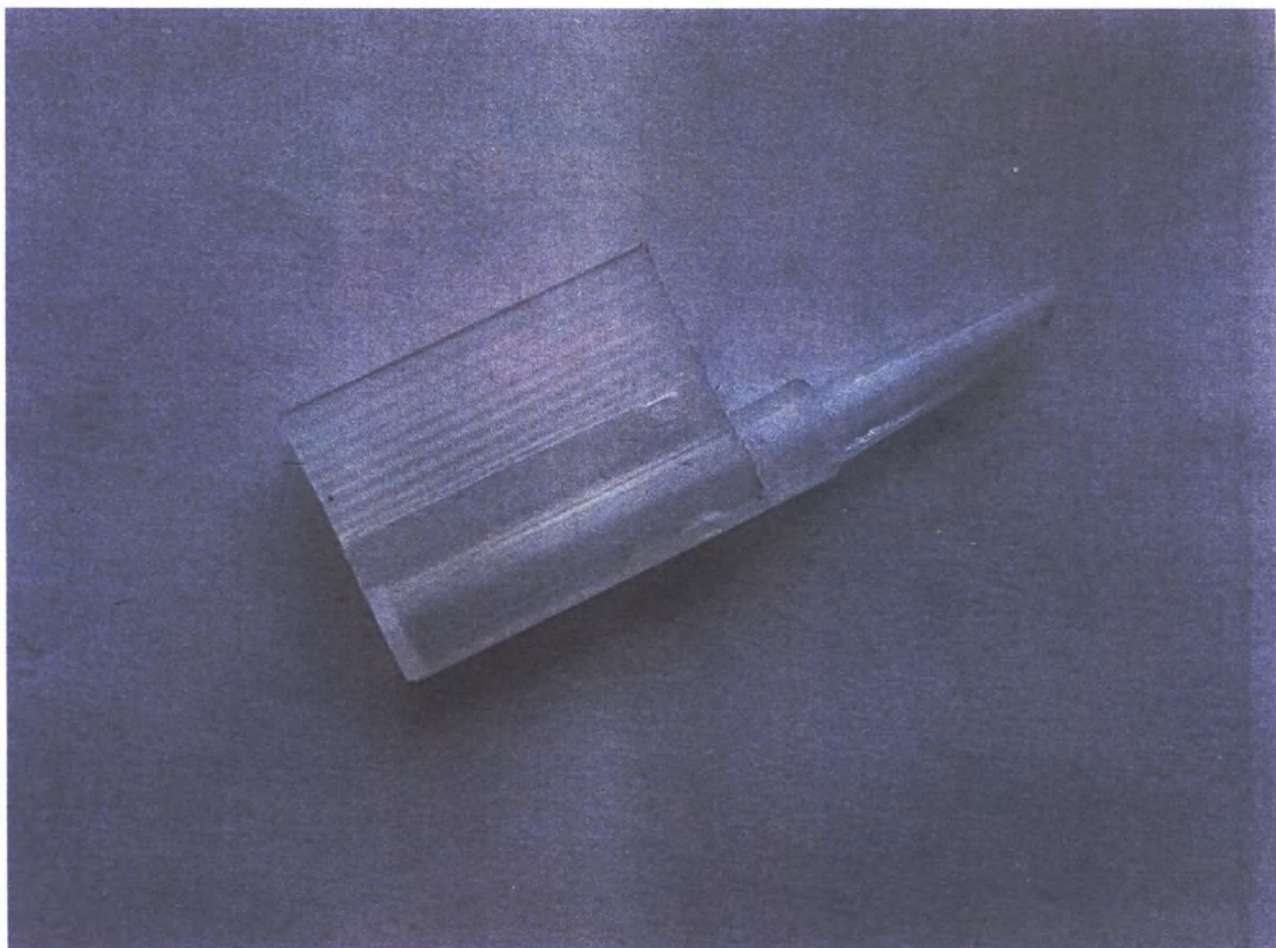


Рисунок 8 – Картридж.

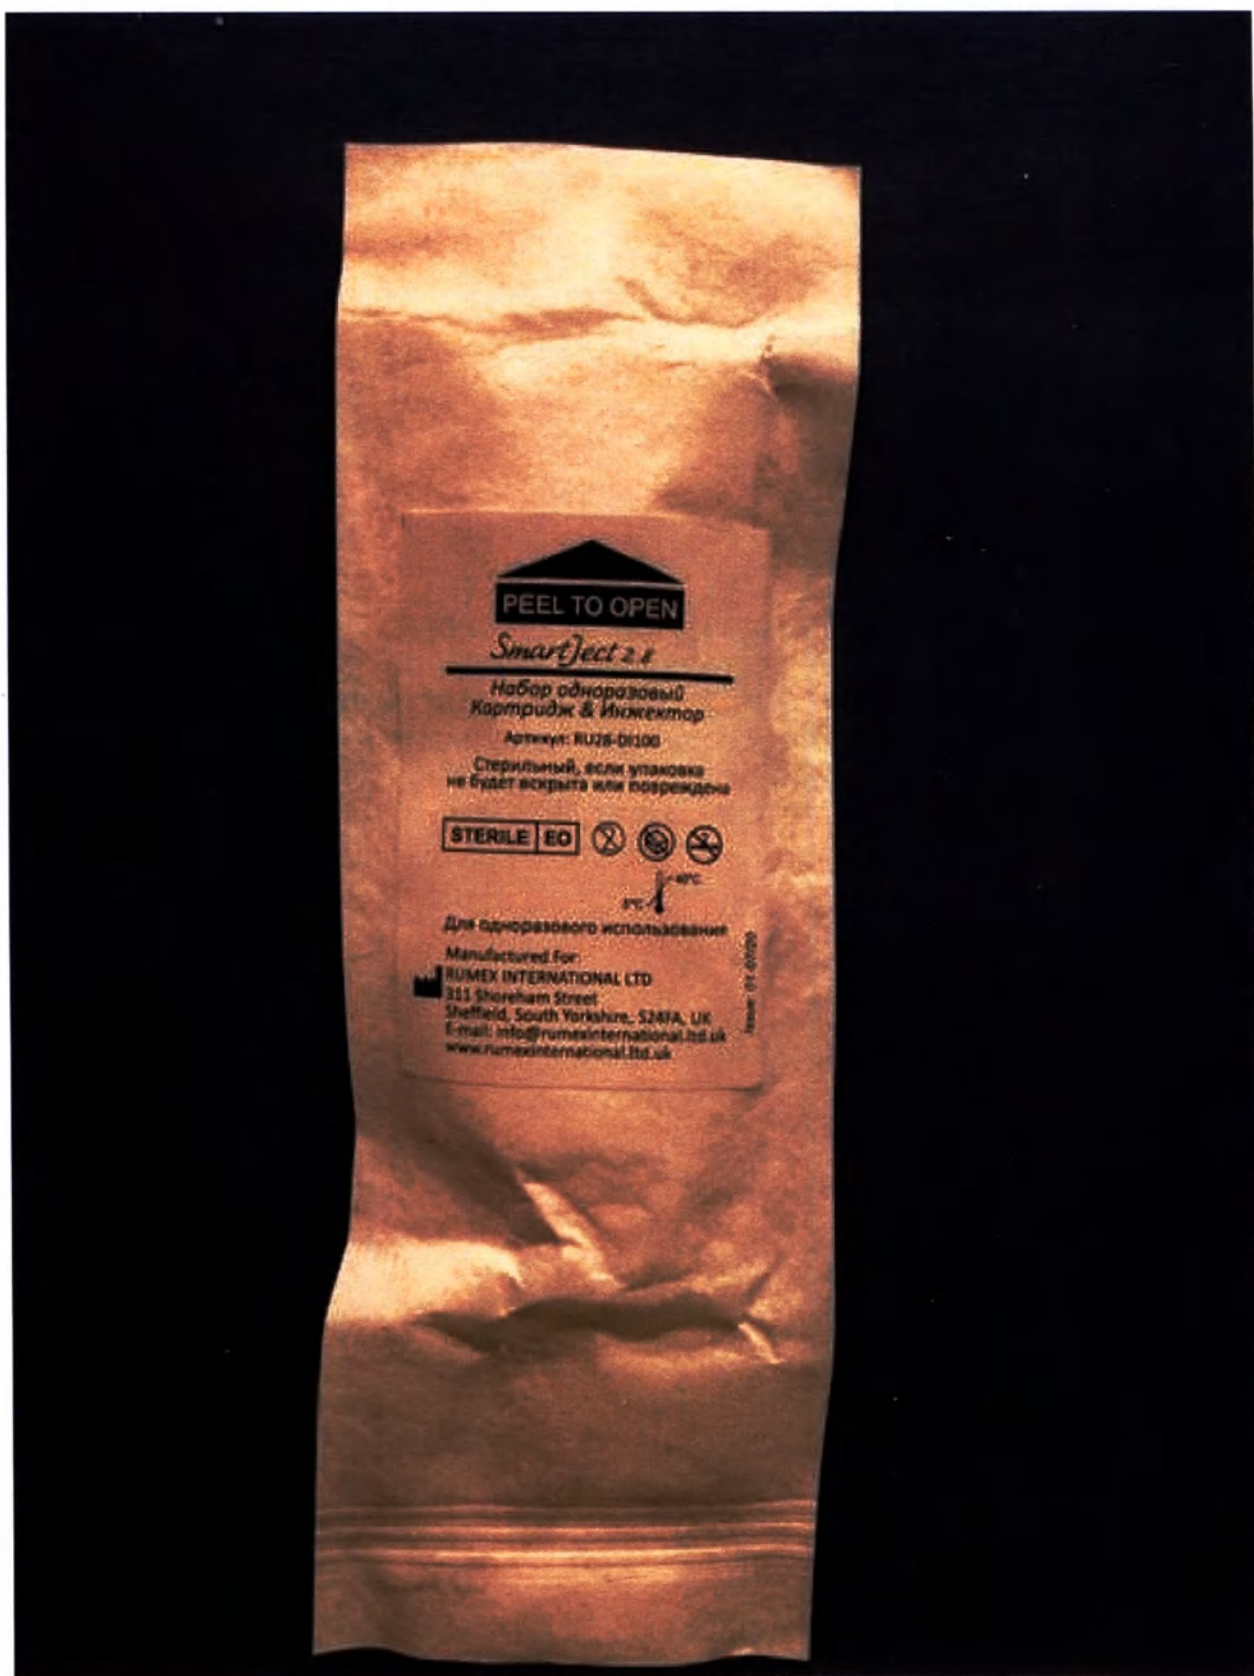


Рисунок 9 – Индивидуальная упаковка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ SMARTJEST ДЛЯ
ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
SMARTJEST 2.8, SMARTJEST 2.2

1

Рисунок 10 – Инструкция по применению.

Вариант исполнения SmartJect 2.2



Рисунок 11 – Потребительская упаковка, вид спереди

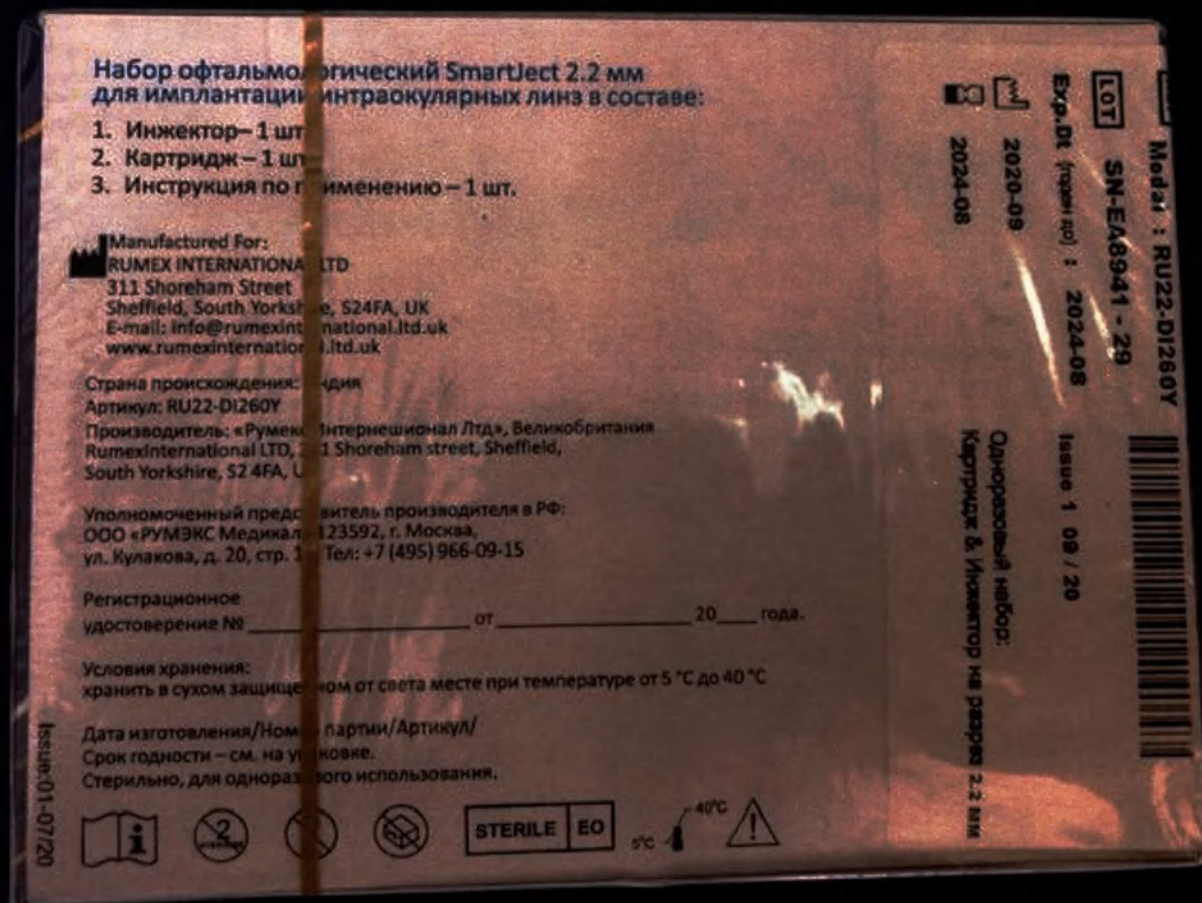


Рисунок 12 – Потребительская упаковка, вид сзади

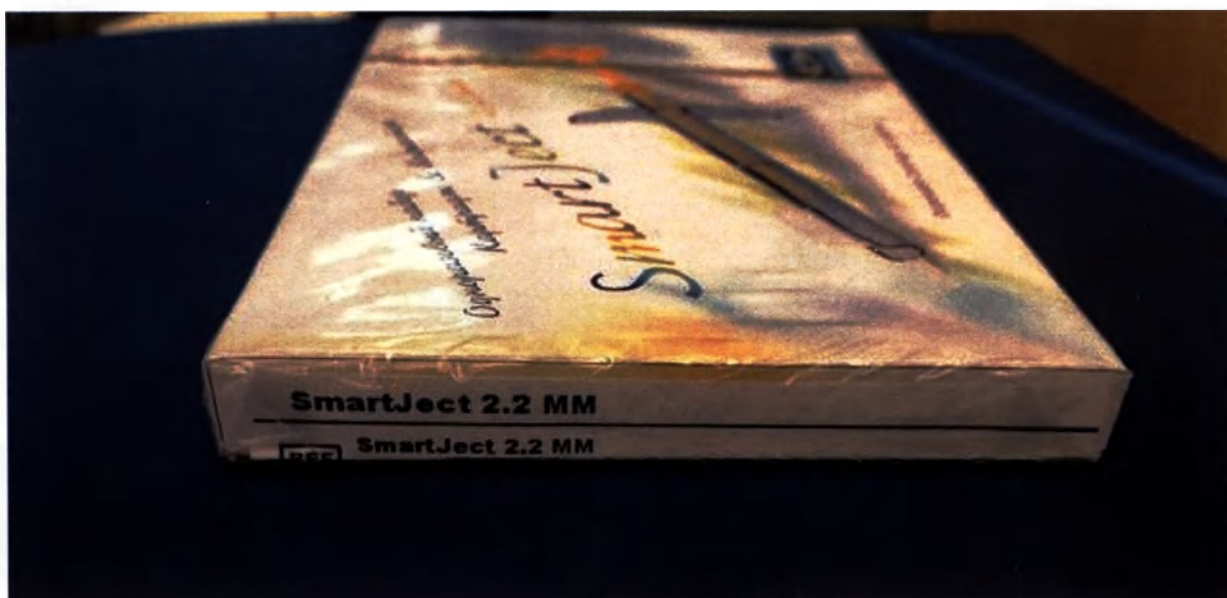


Рисунок 13 – Потребительская упаковка, вид сбоку 1



Рисунок 14 – Потребительская упаковка, вид сбоку 2

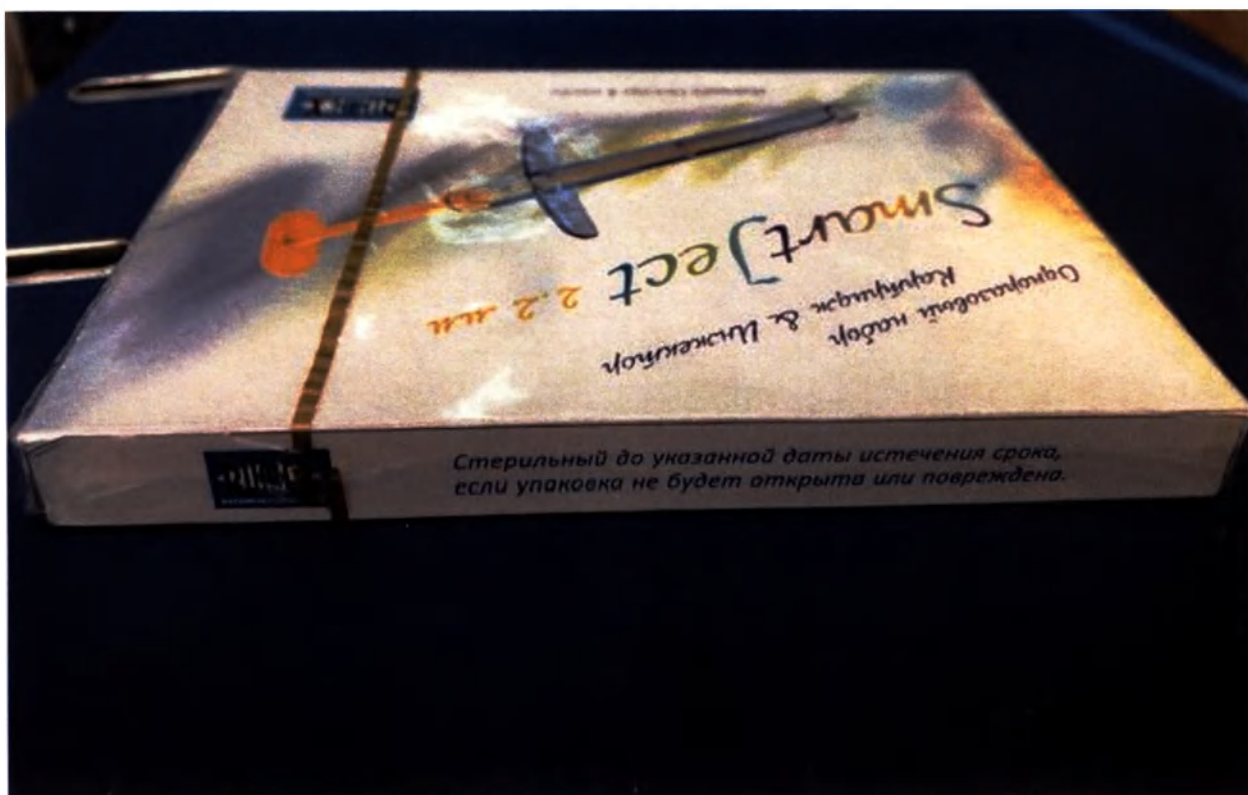


Рисунок 15 – Потребительская упаковка, вид сверху

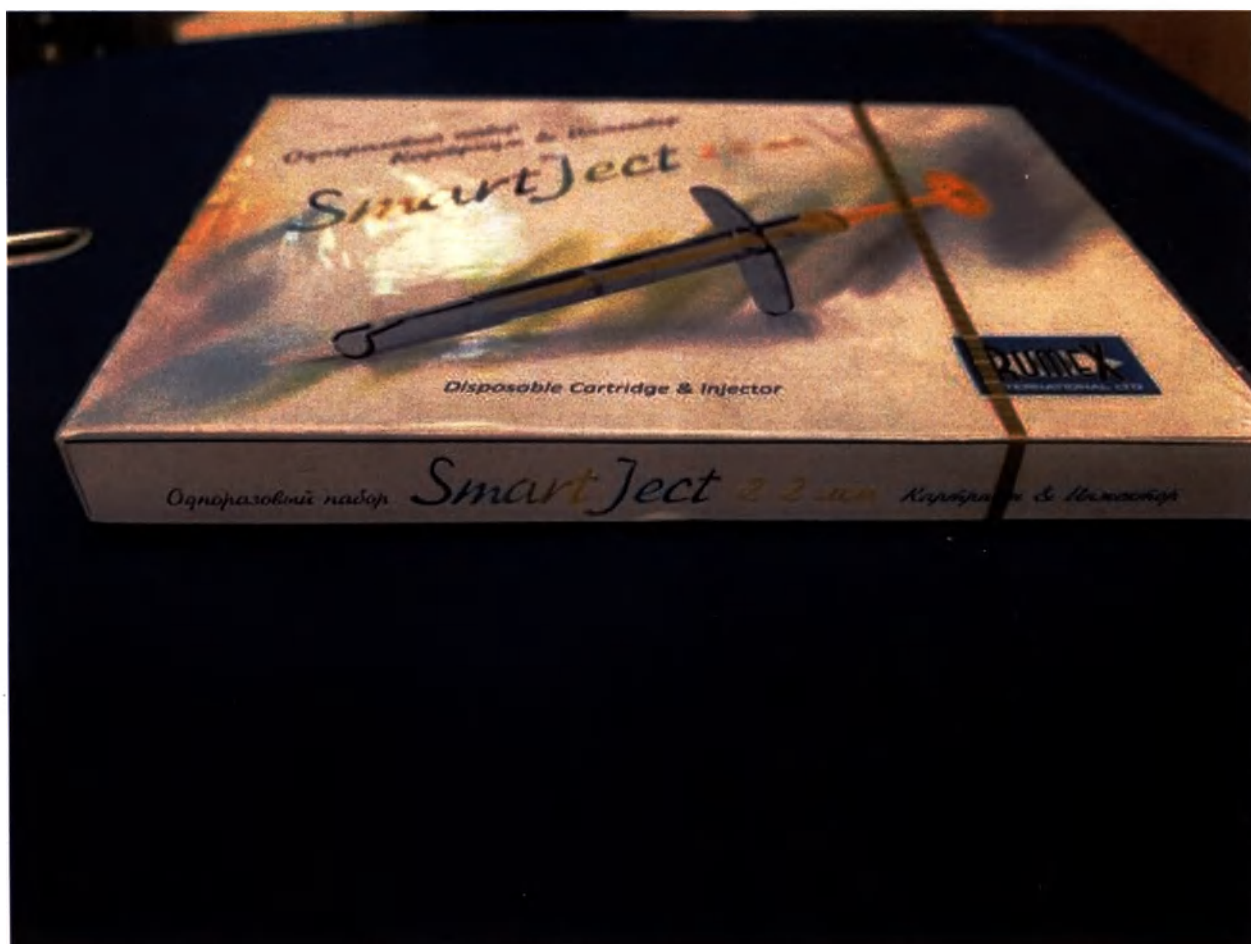


Рисунок 16 – Потребительская упаковка, вид снизу



Рисунок 17 – Инжектор в индивидуальной упаковке.

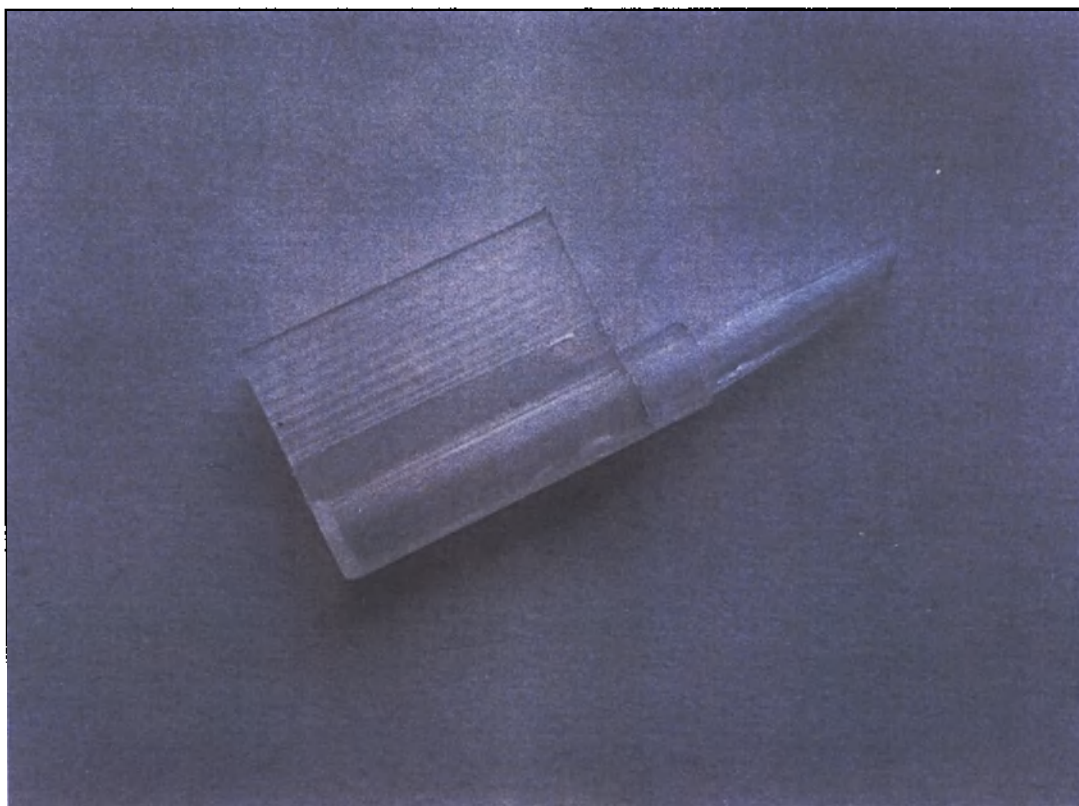


Рисунок 18 – Картридж.



Рисунок 19 – Индивидуальная упаковка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ SMARTJEST ДЛЯ
ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
SMARTJEST 2.8, SMARTJEST 2.2

1

Рисунок 20 – Инструкция по применению.

Прошито, пронумеровано

18/Восемьдесят лист (а/ов)
Скреплено печатью

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
МАКАРОВА Н.В.

