

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО КШТЭ ВОСТОК

Мартин Пьер Колас

_____ 2023 года



Фотографические изображения

Видеоэндоскопы интубационные гибкие FIVE S, одноразовые

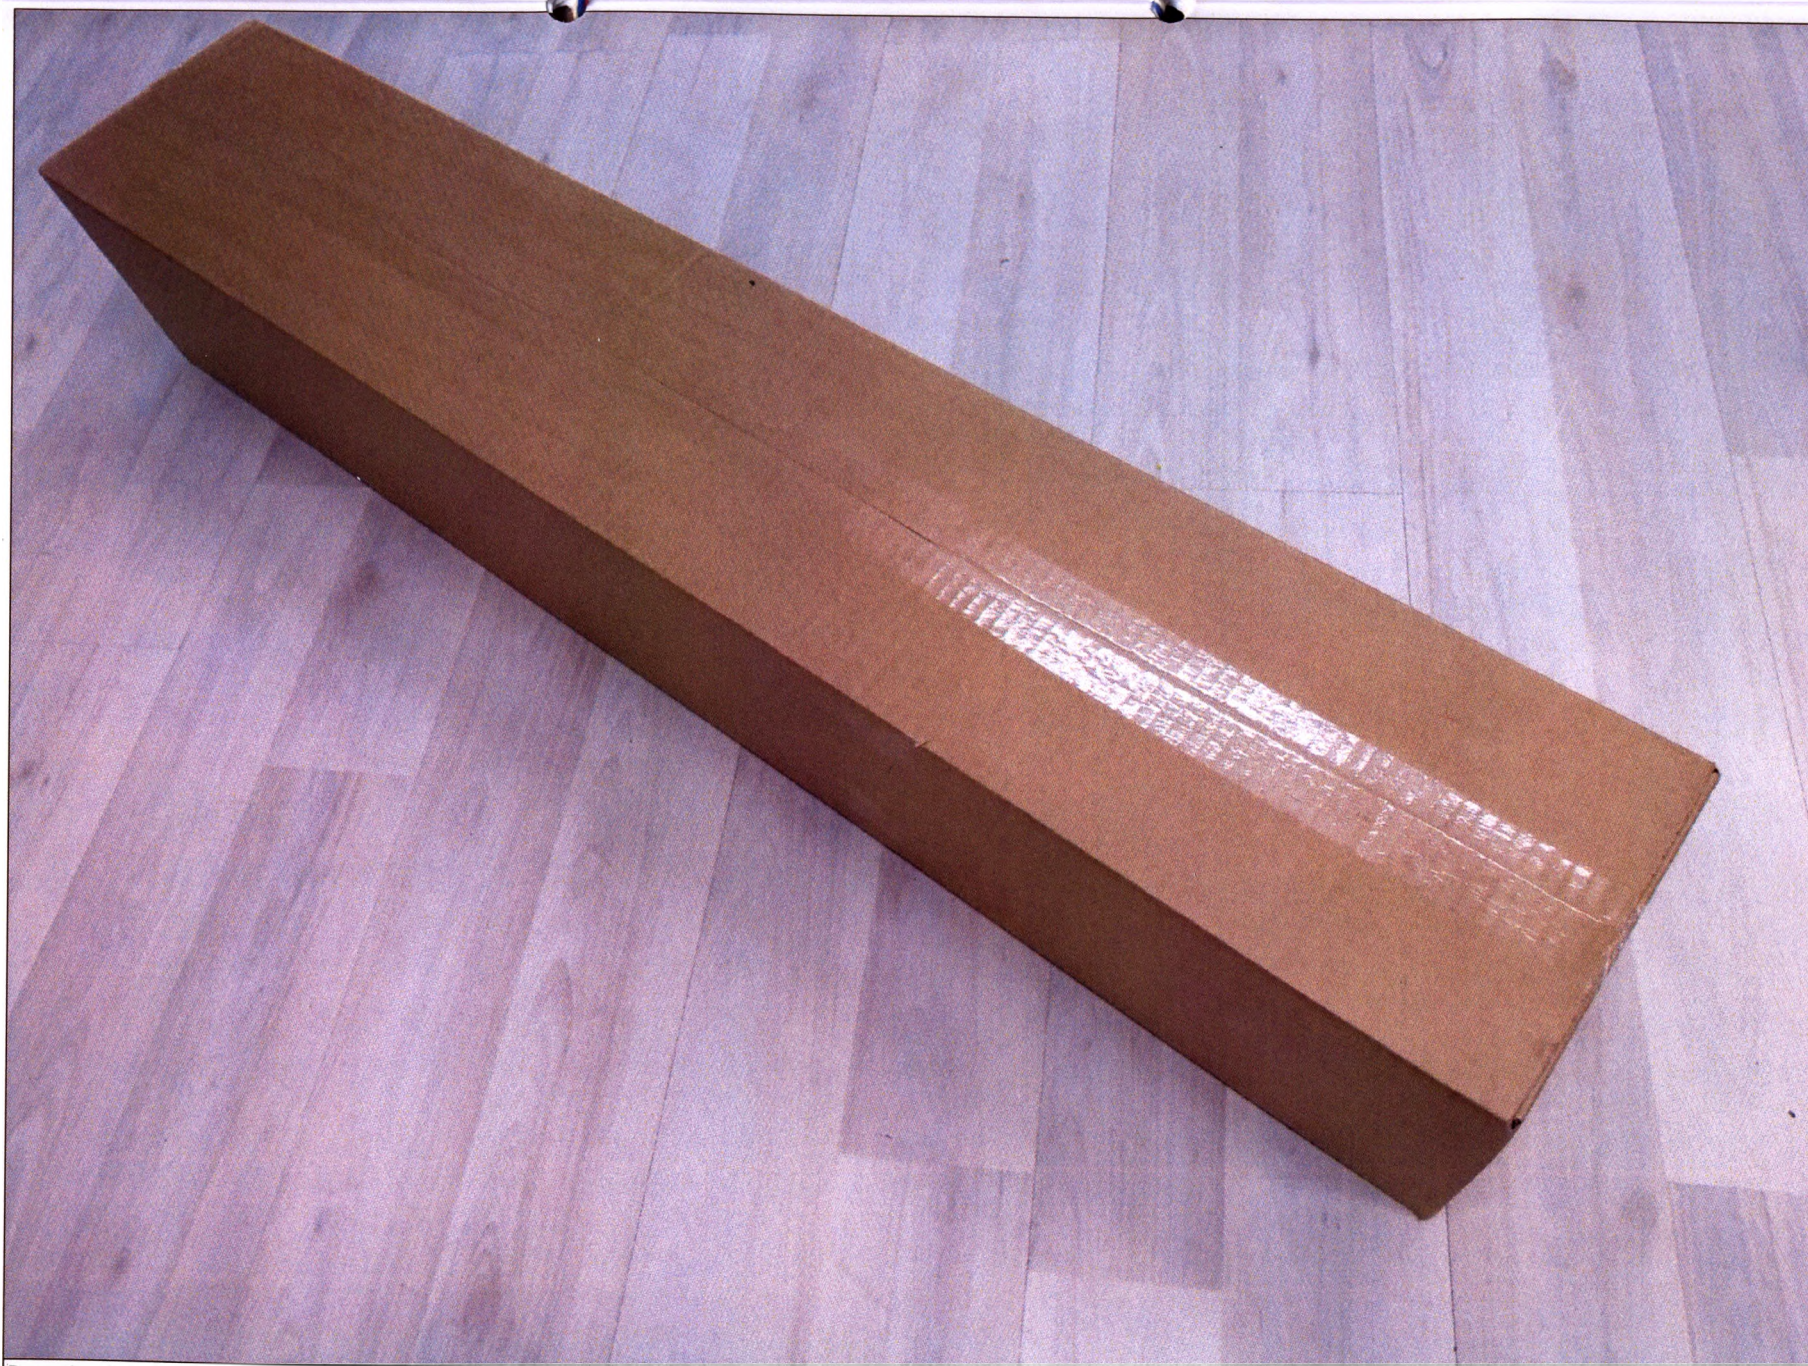


Рис. 1. Видеозэндоскопы интубационные гибкие FIVE S 3.5 x 65, стерильные, одноразовые, 6 шт./уп. Транспортная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm



LOT 500092979

REF 091361-06

QTY 1

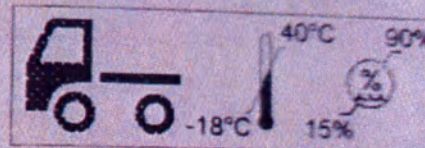

de FIVE S 3.5x65, steril zum Einmalgebrauch
en FIVE S 3.5x65, sterile, for single use
fr FIVE S 3.5x65, stérile, à usage unique
it FIVE S 3.5x65, sterile, monouso
es FIVE S 3.5x65, estéril, para un solo uso
pt FIVE S 3.5x65, estéril, descartável



LV020002



STERILE EO



2026-06-21

Rx only MD



2023-06-21

www.karlstorz.com/ifu

CE 0123

UDI (01)04048551422519(11)230621(17)260621(10)500092979(422)203

Рис. 2. Видеоэндоскопы интубационные гибкие FIVE S 3.5 x 65, стерильные, одноразовые, 6 шт./уп. Маркировка на транспортной упаковке.

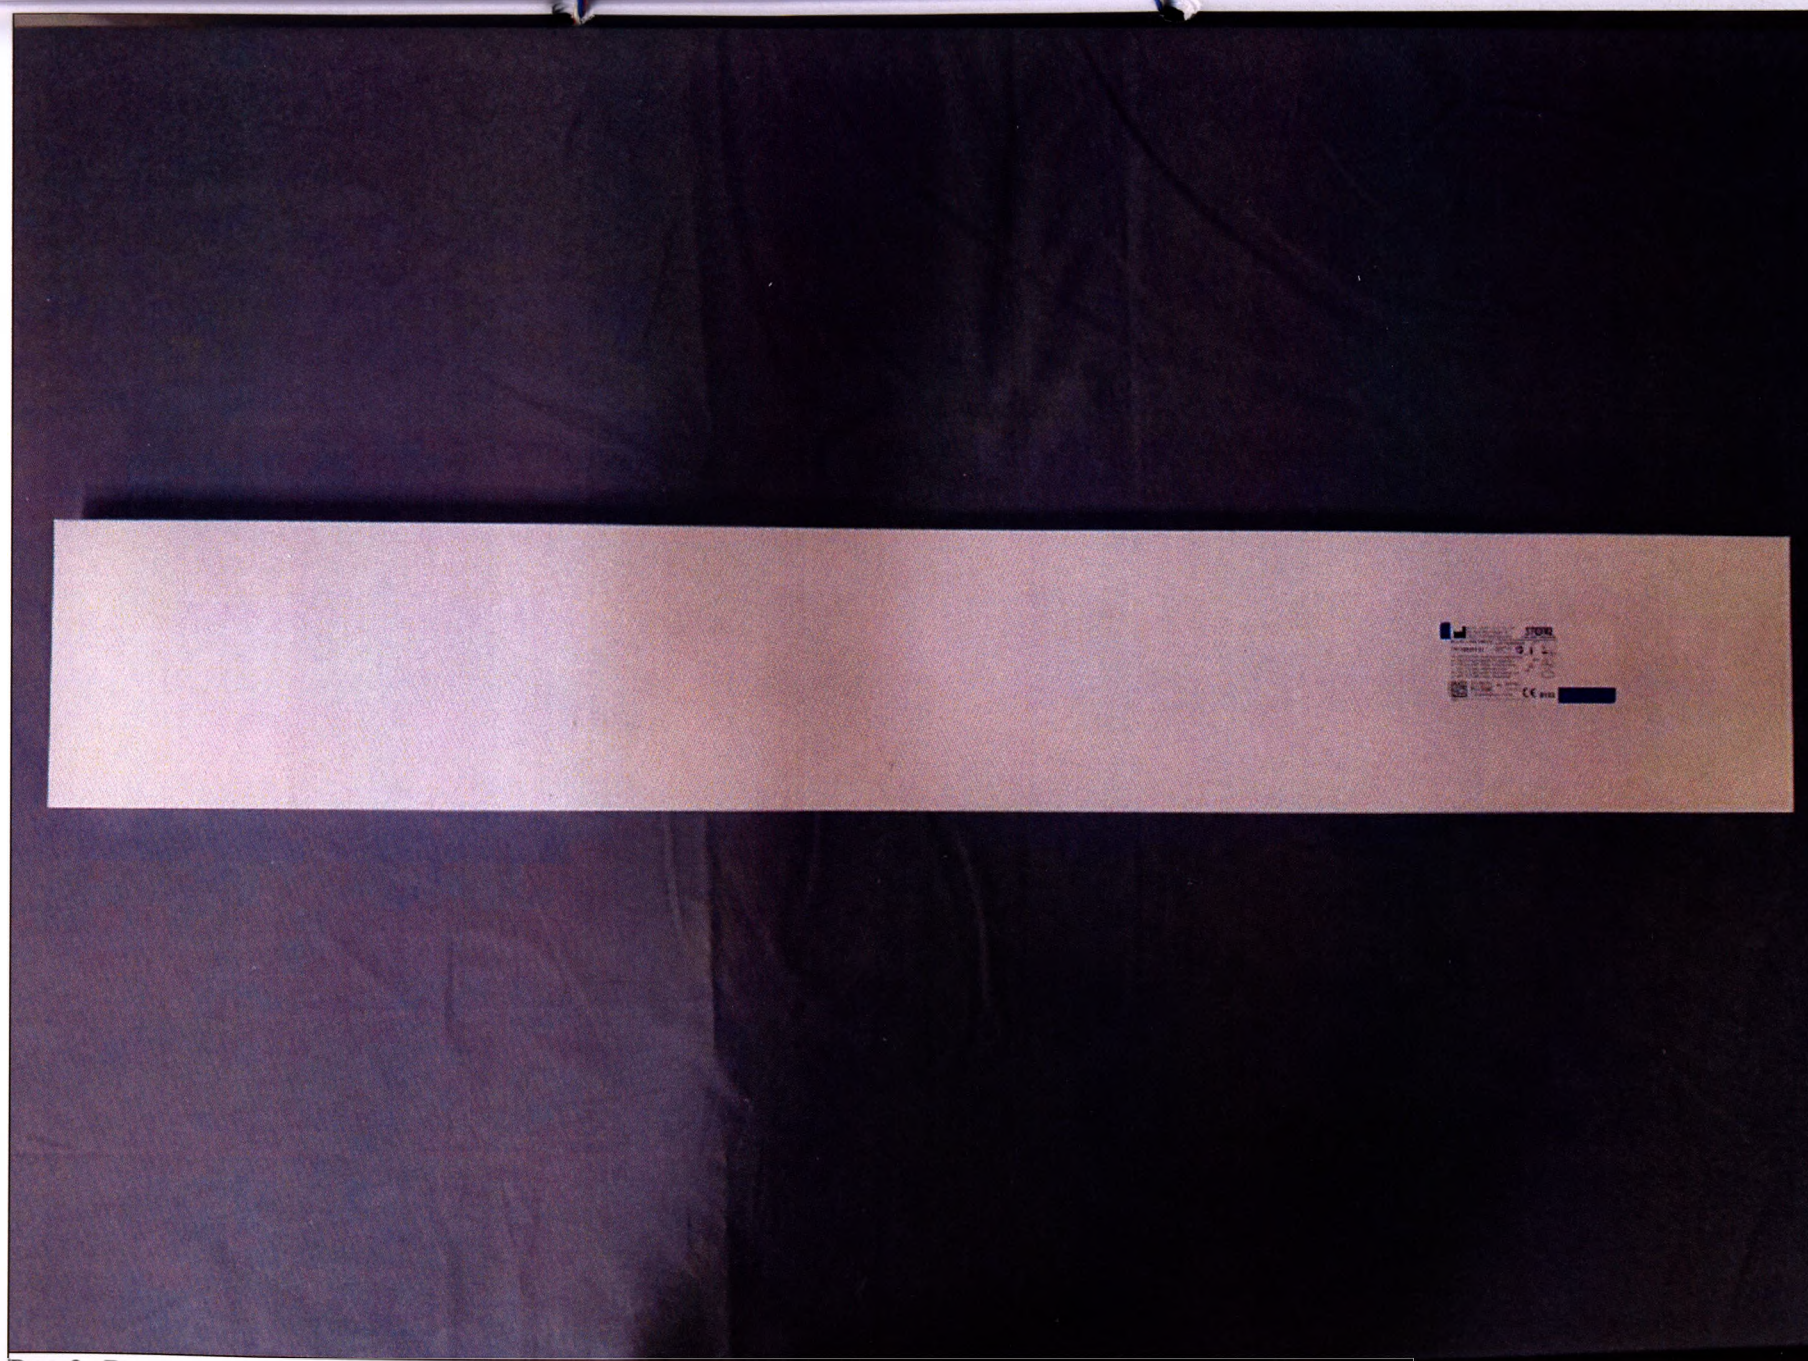


Рис. 3. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Вторичная упаковка.


KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm

REF 091361-01

en FIVE S 3.5x65, sterile for single use

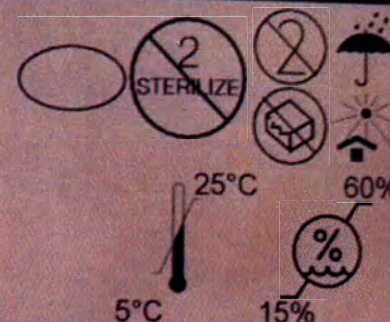

STERILE EO
Rx only MD

2026-06-21
2023-06-21

LOT 500092979
QTY 1

www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551422533(11)230621(17)260621(10)500092979(422)203

CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm QTY 1 LOT 500092979
REF 091361-01
en FIVE S 3.5x65, sterile for single use

STERILE EO 2026-06-21
CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm QTY 1 LOT 500092979
REF 091361-01
en FIVE S 3.5x65, sterile for single use

STERILE EO 2026-06-21
CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm QTY 1 LOT 500092979
REF 091361-01
en FIVE S 3.5x65, sterile for single use

STERILE EO 2026-06-21
CE 0123

Рис. 4. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Маркировка на вторичной упаковке.

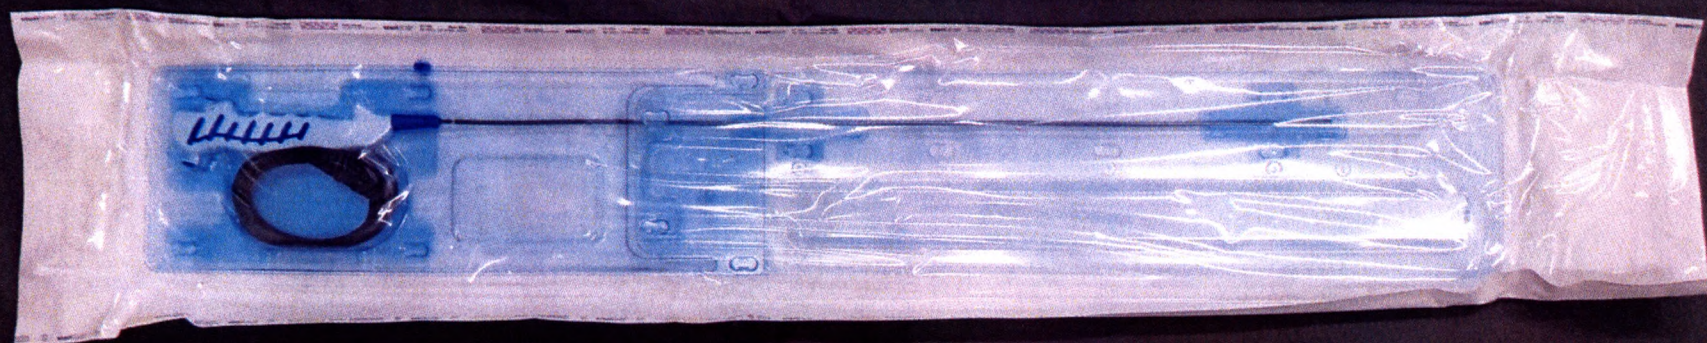


Рис. 5. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Первичная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
 Dr.-Karl-Storz-Straße 34
 78532 Tuttlingen/Germany



 KARL STORZ ENDOSKOPE

Ø 3.5/1.2 mm x 65 cm

LOT 500092979

REF 091361-01
 QTY 1

de FIVE S 3.5x65, steril zum Einmalgebrauch
 en FIVE S 3.5x65, sterile, for single use
 fr FIVE S 3.5x65, stérile, à usage unique
 it FIVE S 3.5x65, sterile, monouso
 es FIVE S 3.5x65, estéril, para un solo uso
 pt FIVE S 3.5x65, estéril, descartável

LV020002
 

STERILE EO
 Rx only
 MD

2026-06-21
 2023-06-21


 0123




www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551422533(11)230621(17)260621(10)500092979(422)203

Рис. 6. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Маркировка на первичной упаковке.

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

7

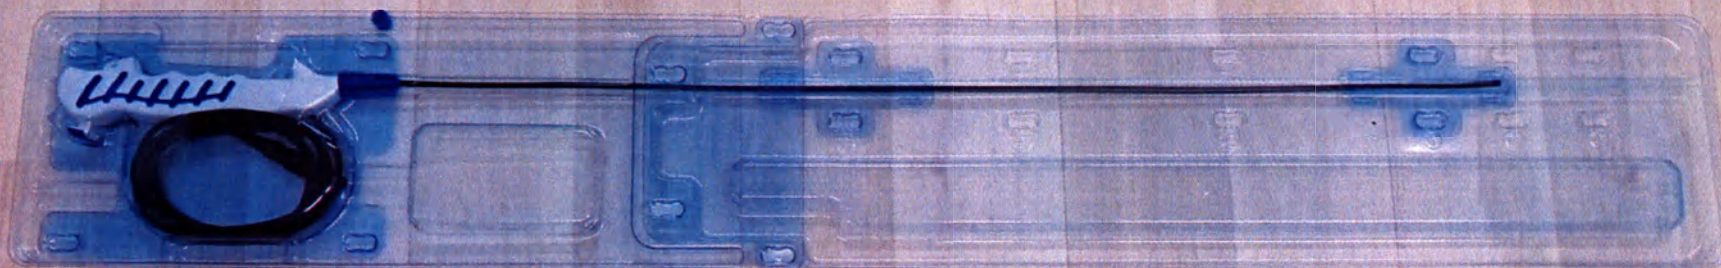


Рис. 7. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый (на подложке).

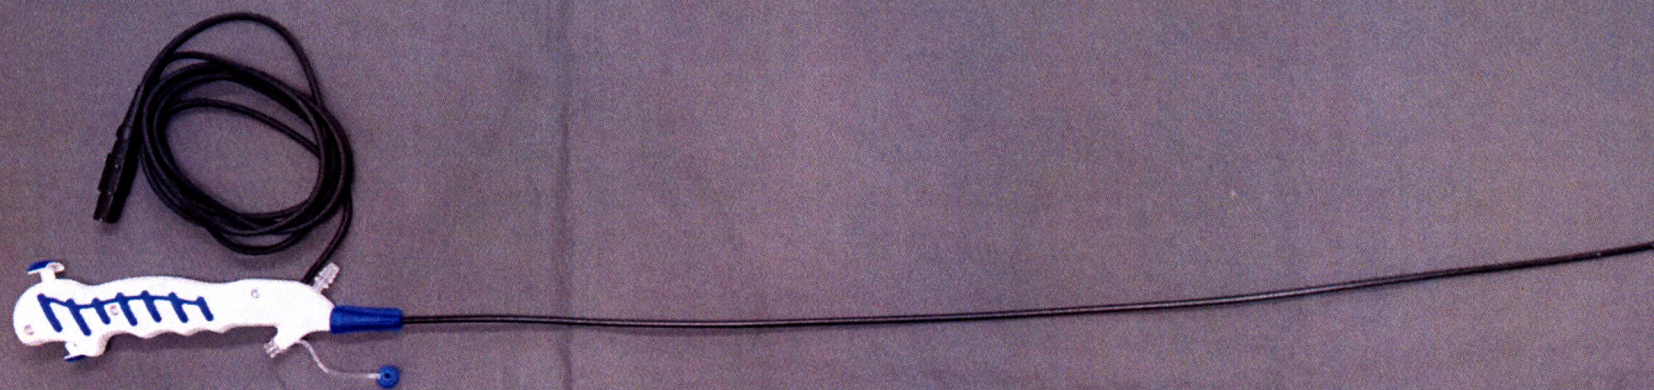


Рис. 8. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Общий вид изделия.

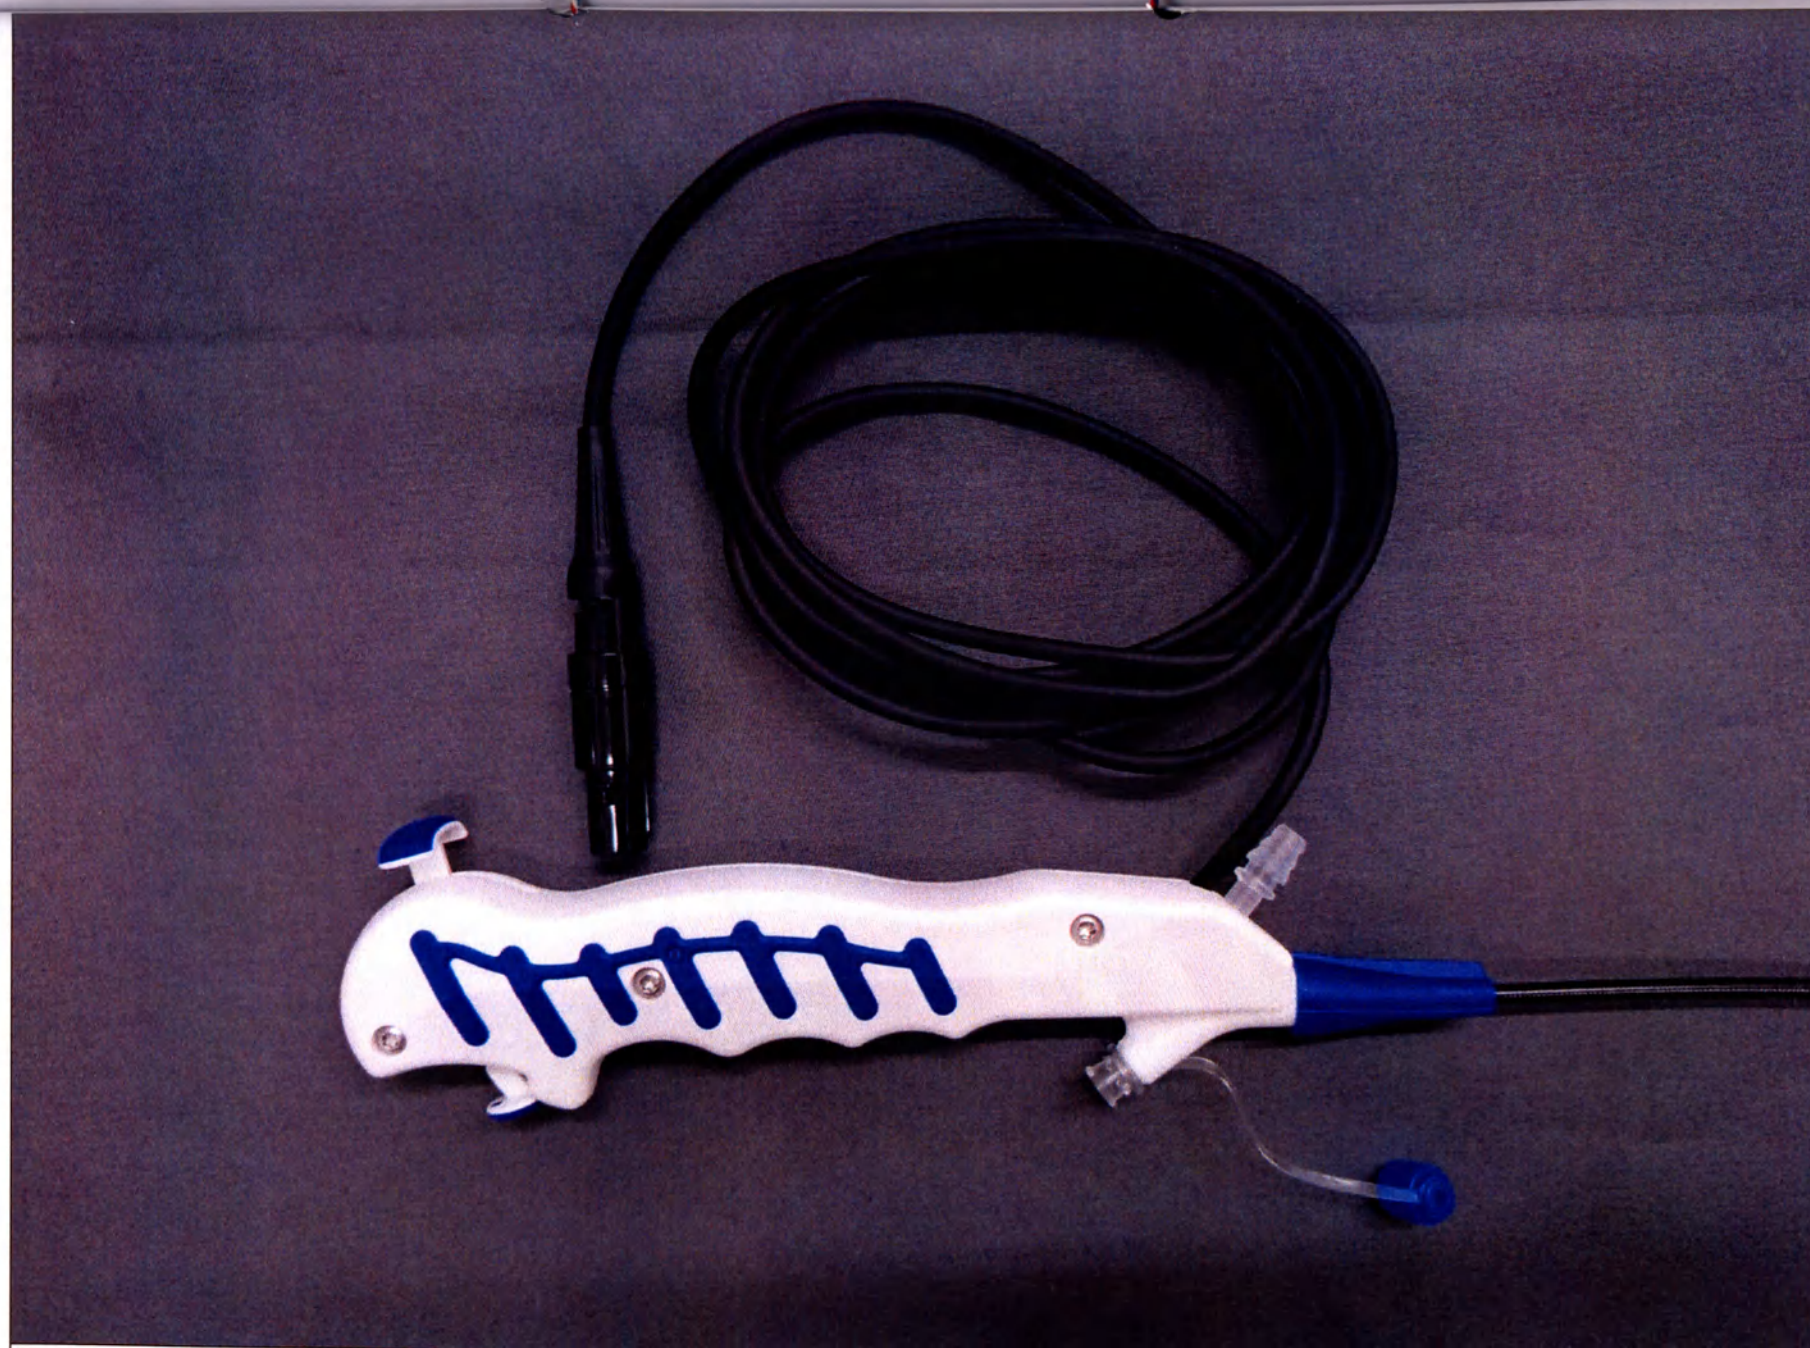


Рис. 9. Видеоэндоскоп интубационный гибкий FIVE S 3.5 x 65, стерильный, одноразовый. Рукоятка изделия и внешний кабель с

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

ru Инструкция по эксплуатации
Видеозэндоскопы интубационные гибкие FIVE S
3,5 x 65, стерильные, одноразовые





Рис. 11. Адаптер Е-Вох. Потребительская упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF TP012

SN UP3016

QTY 1

E-Box f.flex. Endoskope z.Einmalgebrauch
E-Box for flex. single-use Endoscopes
E-Box pour vidéo-endoscope flexible
E-Box, per video-endoscopi flessibili
E-Box para endoscop. flex de un solo uso
E-Box, para videoendoscópios flexíveis



(01)04048551431429(240)TP012(21)UP3016

RxONLY

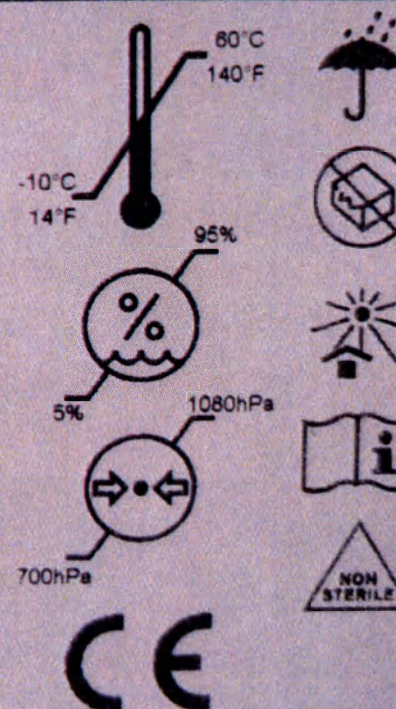


Рис. 12. Адаптер E-Box. Маркировка на потребительской упаковке.



Рис. 13. Адаптер Е-Вох. Потребительская упаковка.



Рис. 14. Адаптер Е-Box.

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE



GEBRAUCHSANWEISUNG
TP 012 E-Box



INSTRUCTION MANUAL
TP 012 E-Box



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TP 012 E-Box



Рис. 15. Адаптер Е-Вох. Инструкция по эксплуатации.

