

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО БЛИЗАР»

С.Е. Моисеев

16 июня 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**РЕАГЕНТ «CD1» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОГИДРАТ-ДЕФИЦИТНОГО
ТРАНСФЕРРИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ НА ХРОМАТОГРАФЕ ЖИДКОСТНОМ
ПОРТАТИВНОМ «БЛИЗАР CDT» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO,**

ТУ 20.59.52-002-45629787-2021

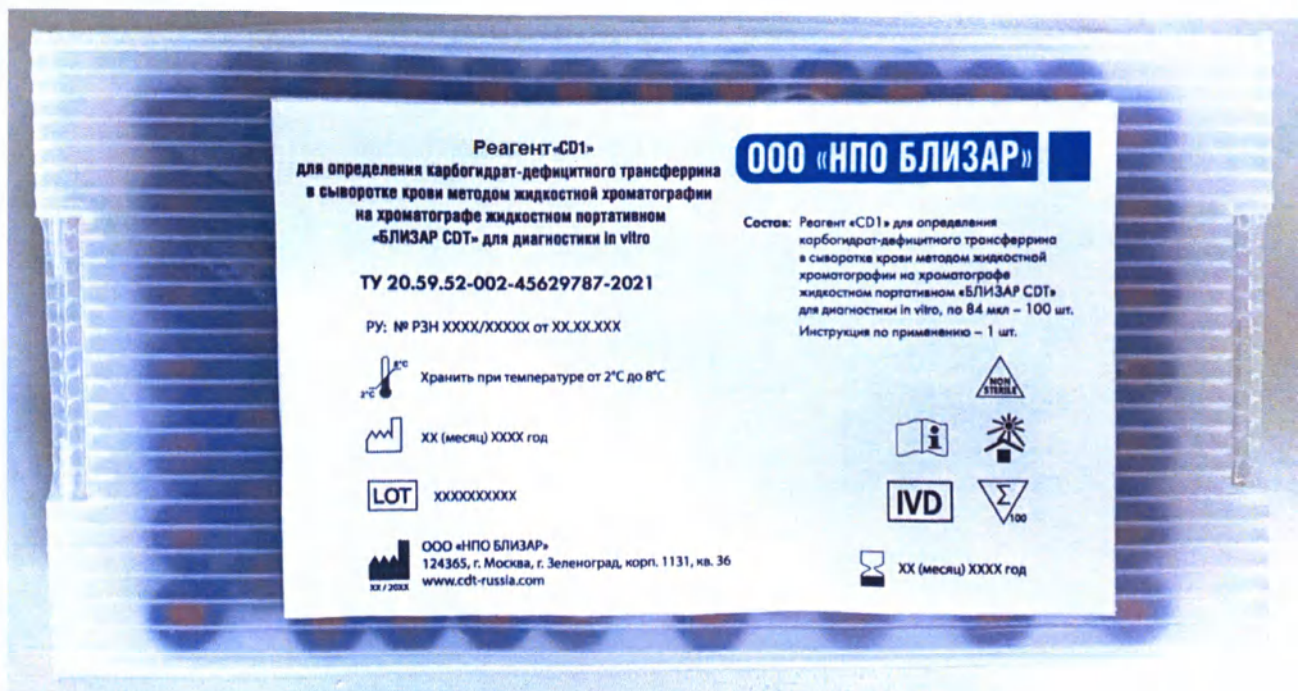


Рисунок 1 – Общий вид медицинского изделия «Реагент CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021 Ракурс 1

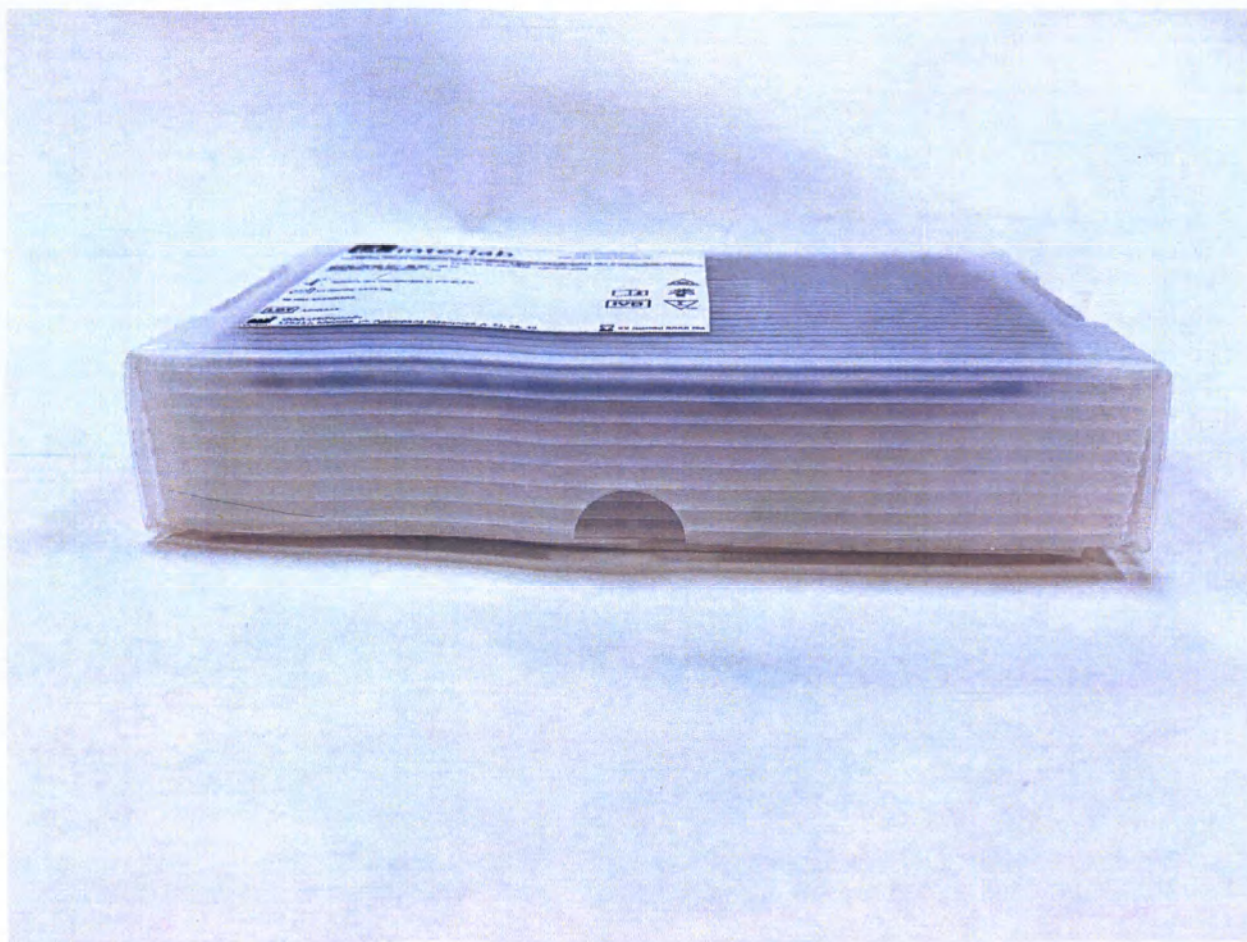


Рисунок 2 – Общий вид медицинского изделия «Реагент CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021 Ракурс 2

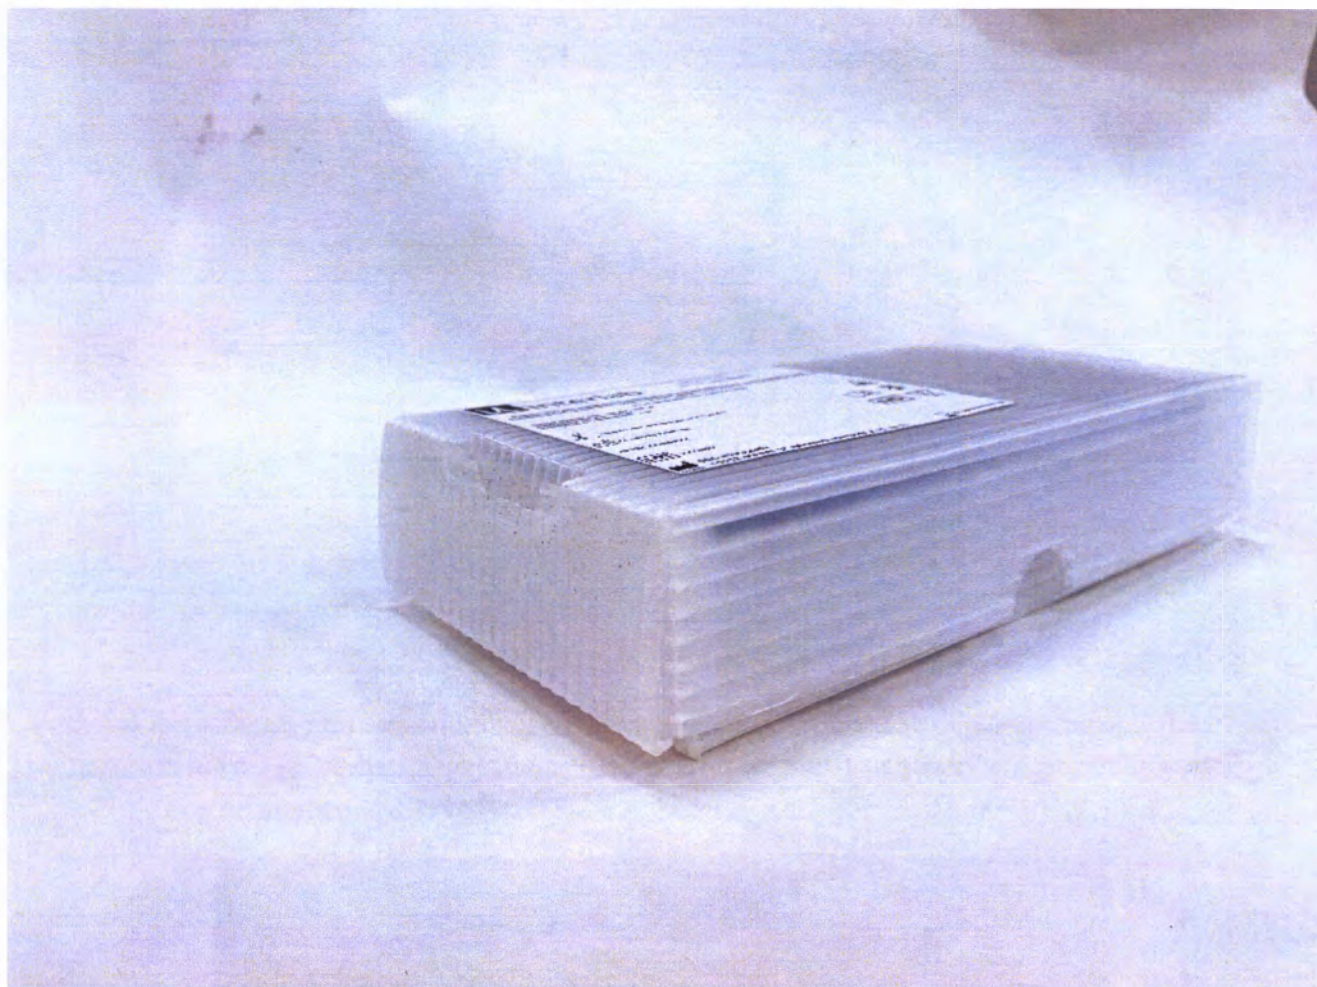


Рисунок 3 – Общий вид медицинского изделия «Реагент CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021 Ракурс 3

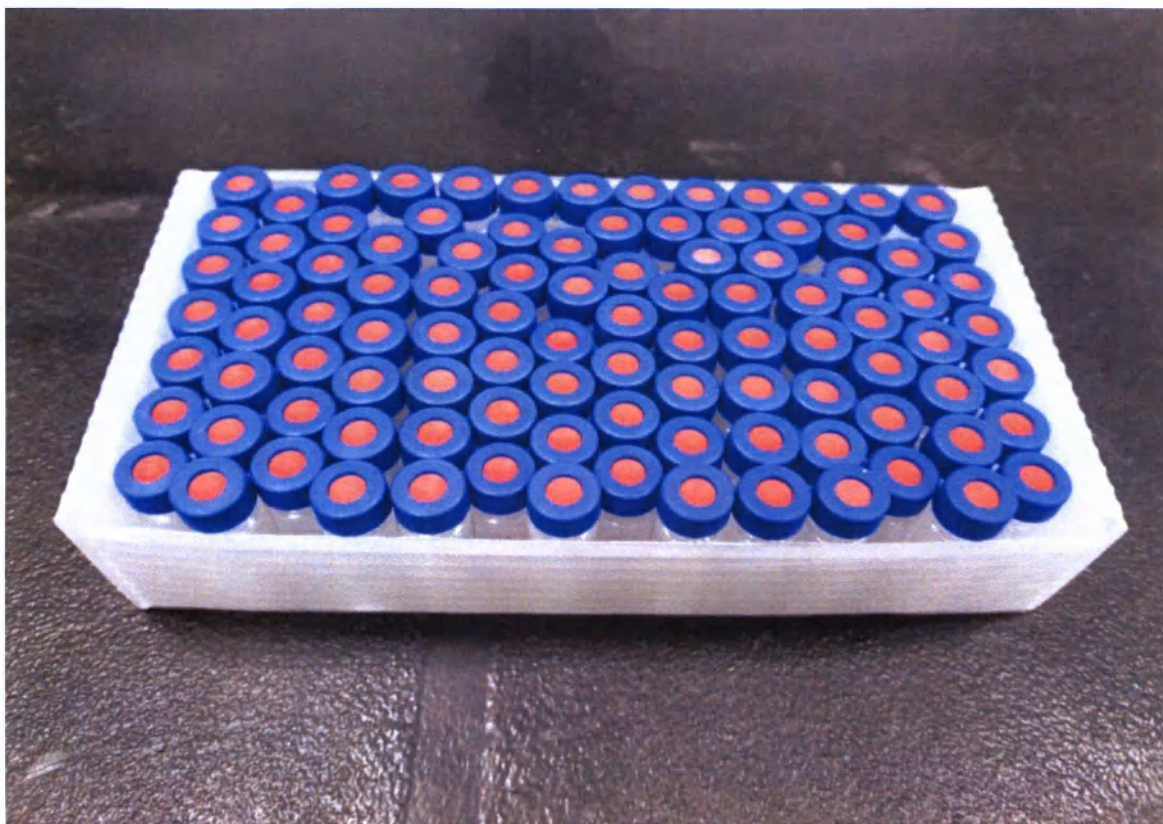


Рисунок 4 – Общий вид медицинского изделия «Реагент CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021 Ракурс 4

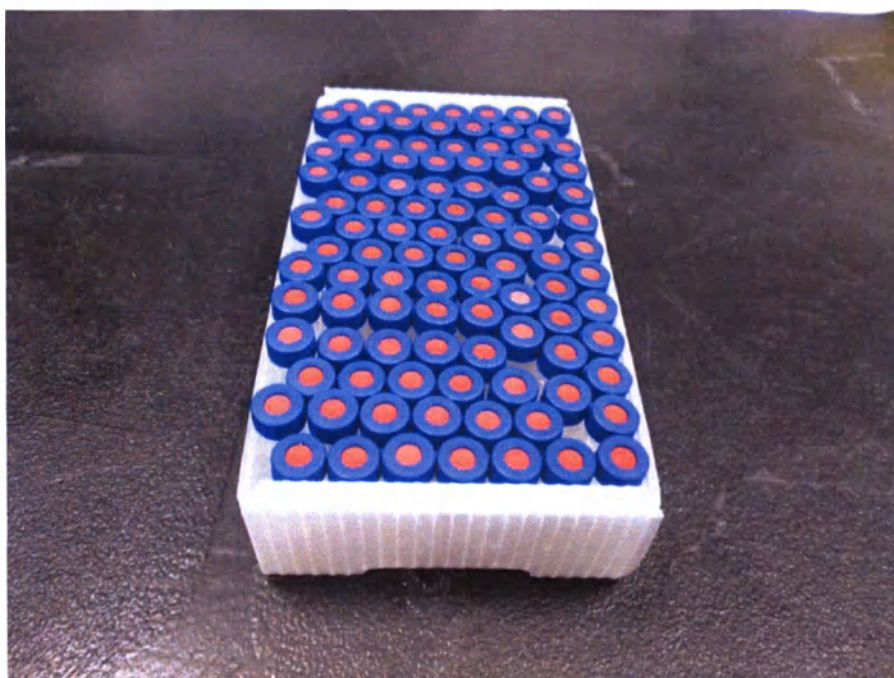


Рисунок 5 – Общий вид медицинского изделия «Реагент CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021 Ракурс 5



Рисунок 6 – Микровиала реагента CD1 для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови с помощью хроматографа жидкостного портативного «БЛИЗАР CDT», ТУ 20.59.52-002-45629787-2021

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (темь) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО «Близар»
Моисеев Сергей Евгеньевич

(подпись)



М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО БЛИЗАР»

С.В. Моисеев

2021 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

РЕАГЕНТ «CD1» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОГИДРАТ-ДЕФИЦИТНОГО
ТРАНСФЕРРИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ НА ХРОМАТОГРАФЕ ЖИДКОСТНОМ
ПОРТАТИВНОМ «БЛИЗАР CDT» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO,

ТУ 20.59.52-002-45629787-2021

1. Макет маркировки компонента



Рисунок 1 – Макет маркировки компонента

2. Макет маркировки групповой упаковки

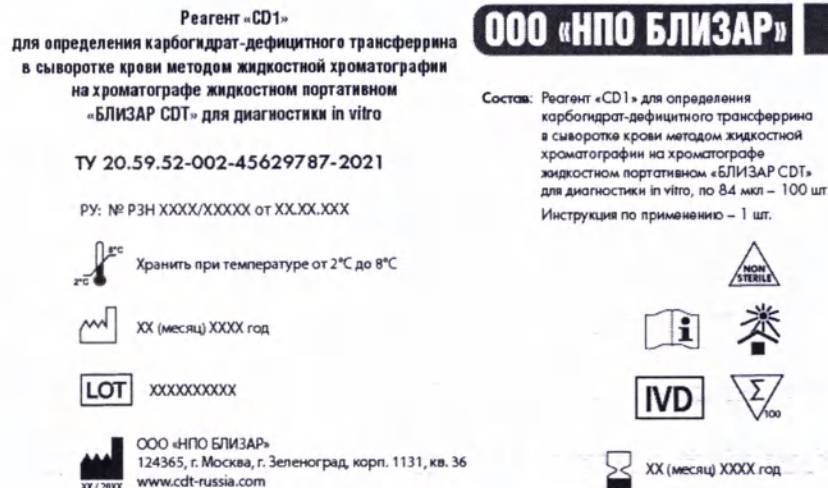


Рисунок 2 – Макет маркировки групповой (потребительской) упаковки

3. Макет маркировки транспортной упаковки

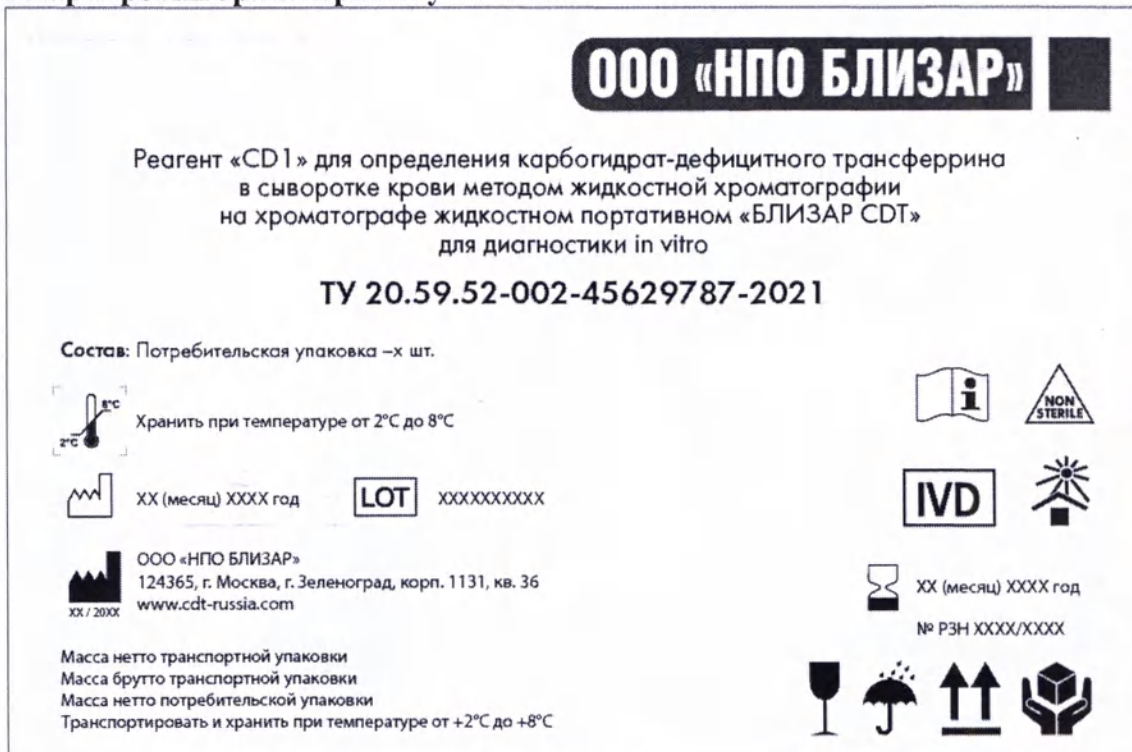


Рисунок 3 – Макет маркировки транспортной упаковки

4. Символы, используемые в маркировке медицинского изделия

Описание

Символ



Медицинское изделие для диагностики in vitro




Изготовитель



Использовать до



Код партии



Обратитесь к инструкции по применению



Температурный диапазон



Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов



Дата производства



Не допускать воздействия солнечного света



Не стерильно



Беречь от влаги



Хрупкое, обращаться осторожно



Верх

Обращаться с осторожностью

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО «Близар»
Моисеев Сергей Евгеньевич

(подпись)



М.П.

