


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Уровест»
В.В.Данилов




23 июня 2021г


Фотографические изображения медицинского изделия

Общий вид медицинского изделия

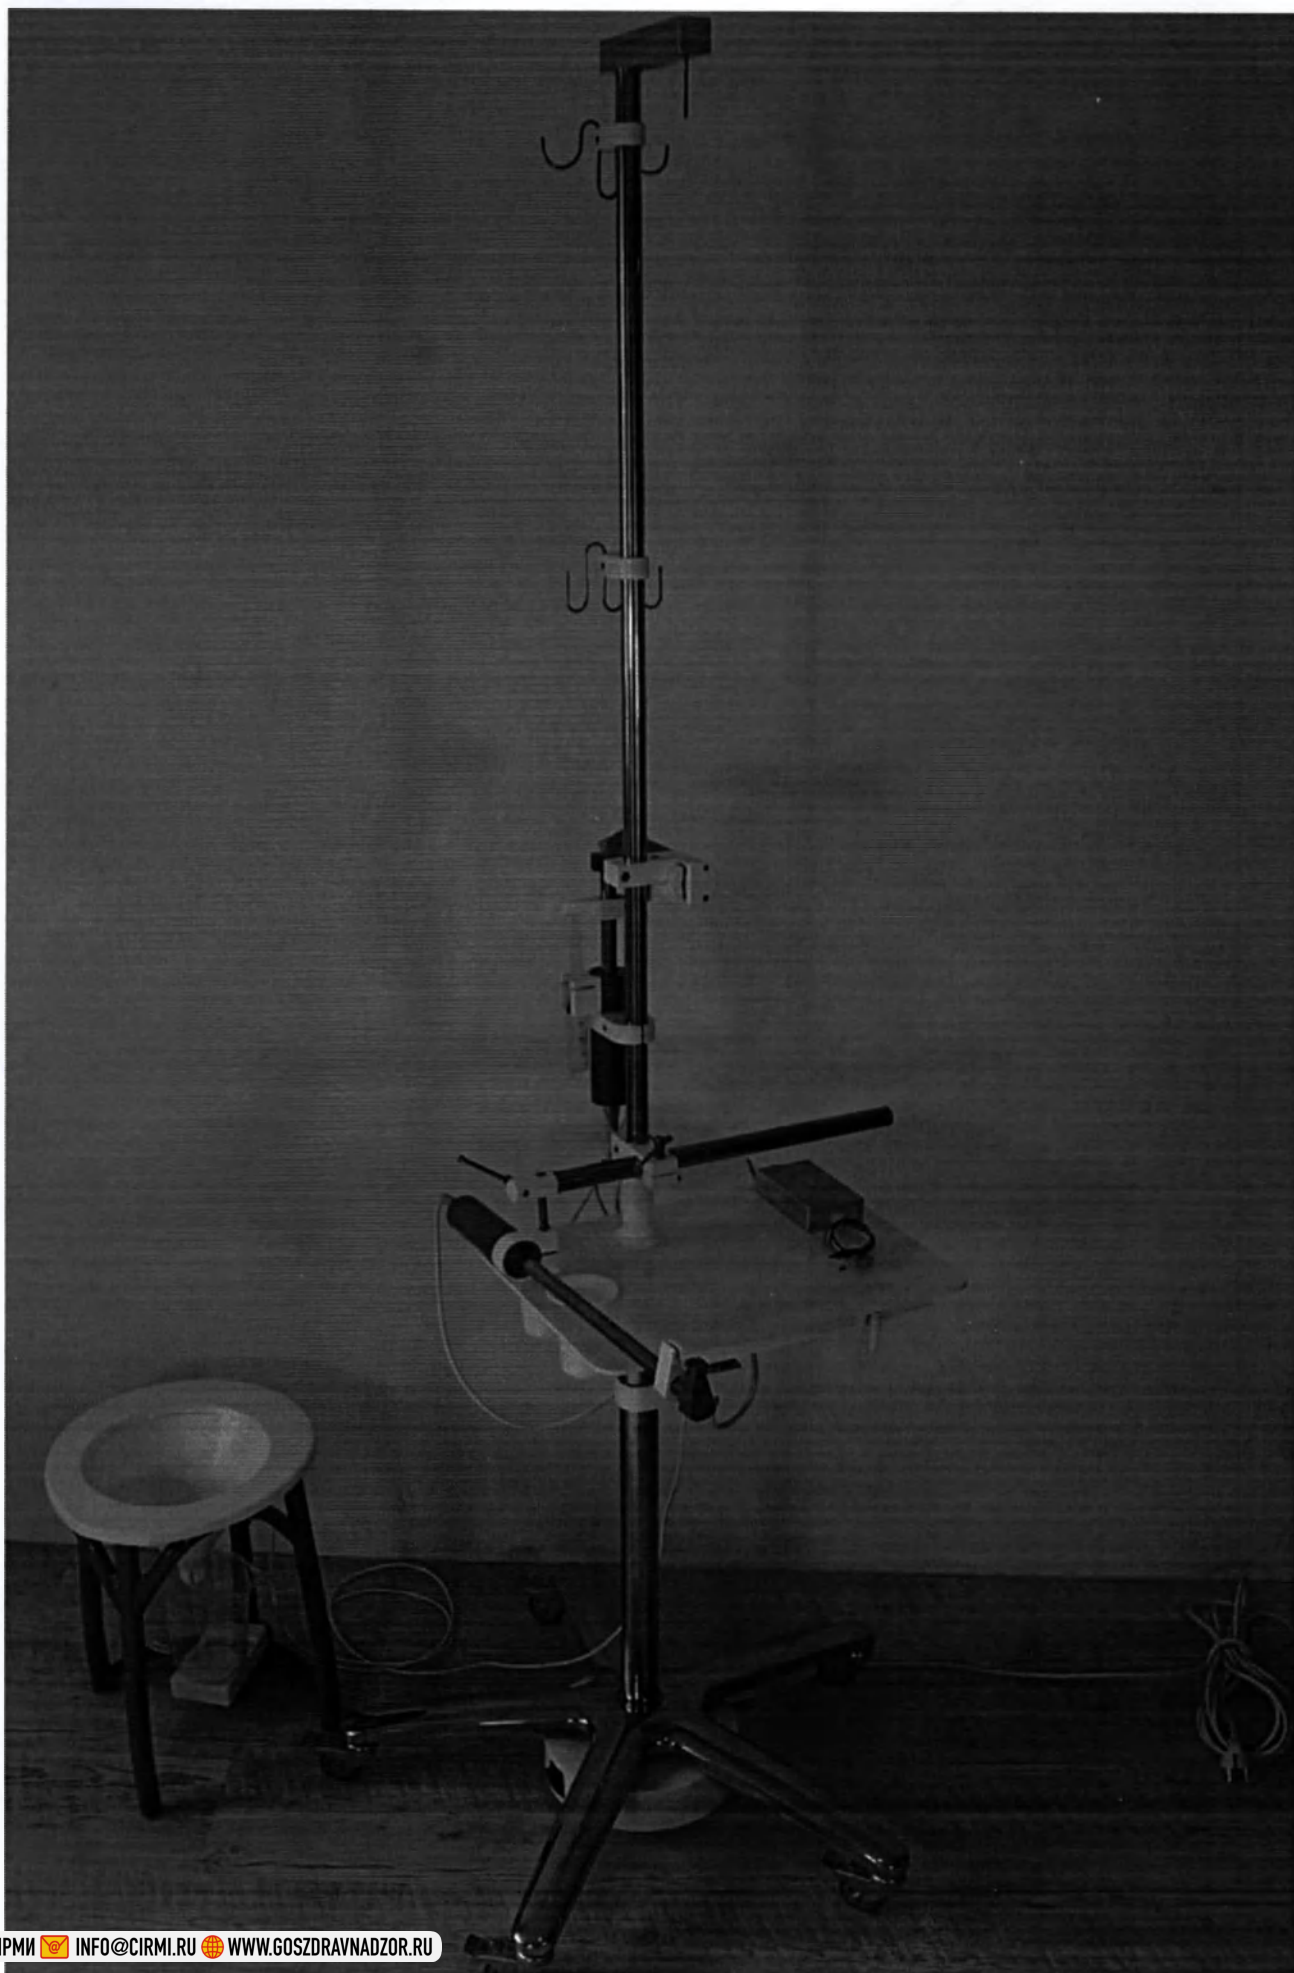

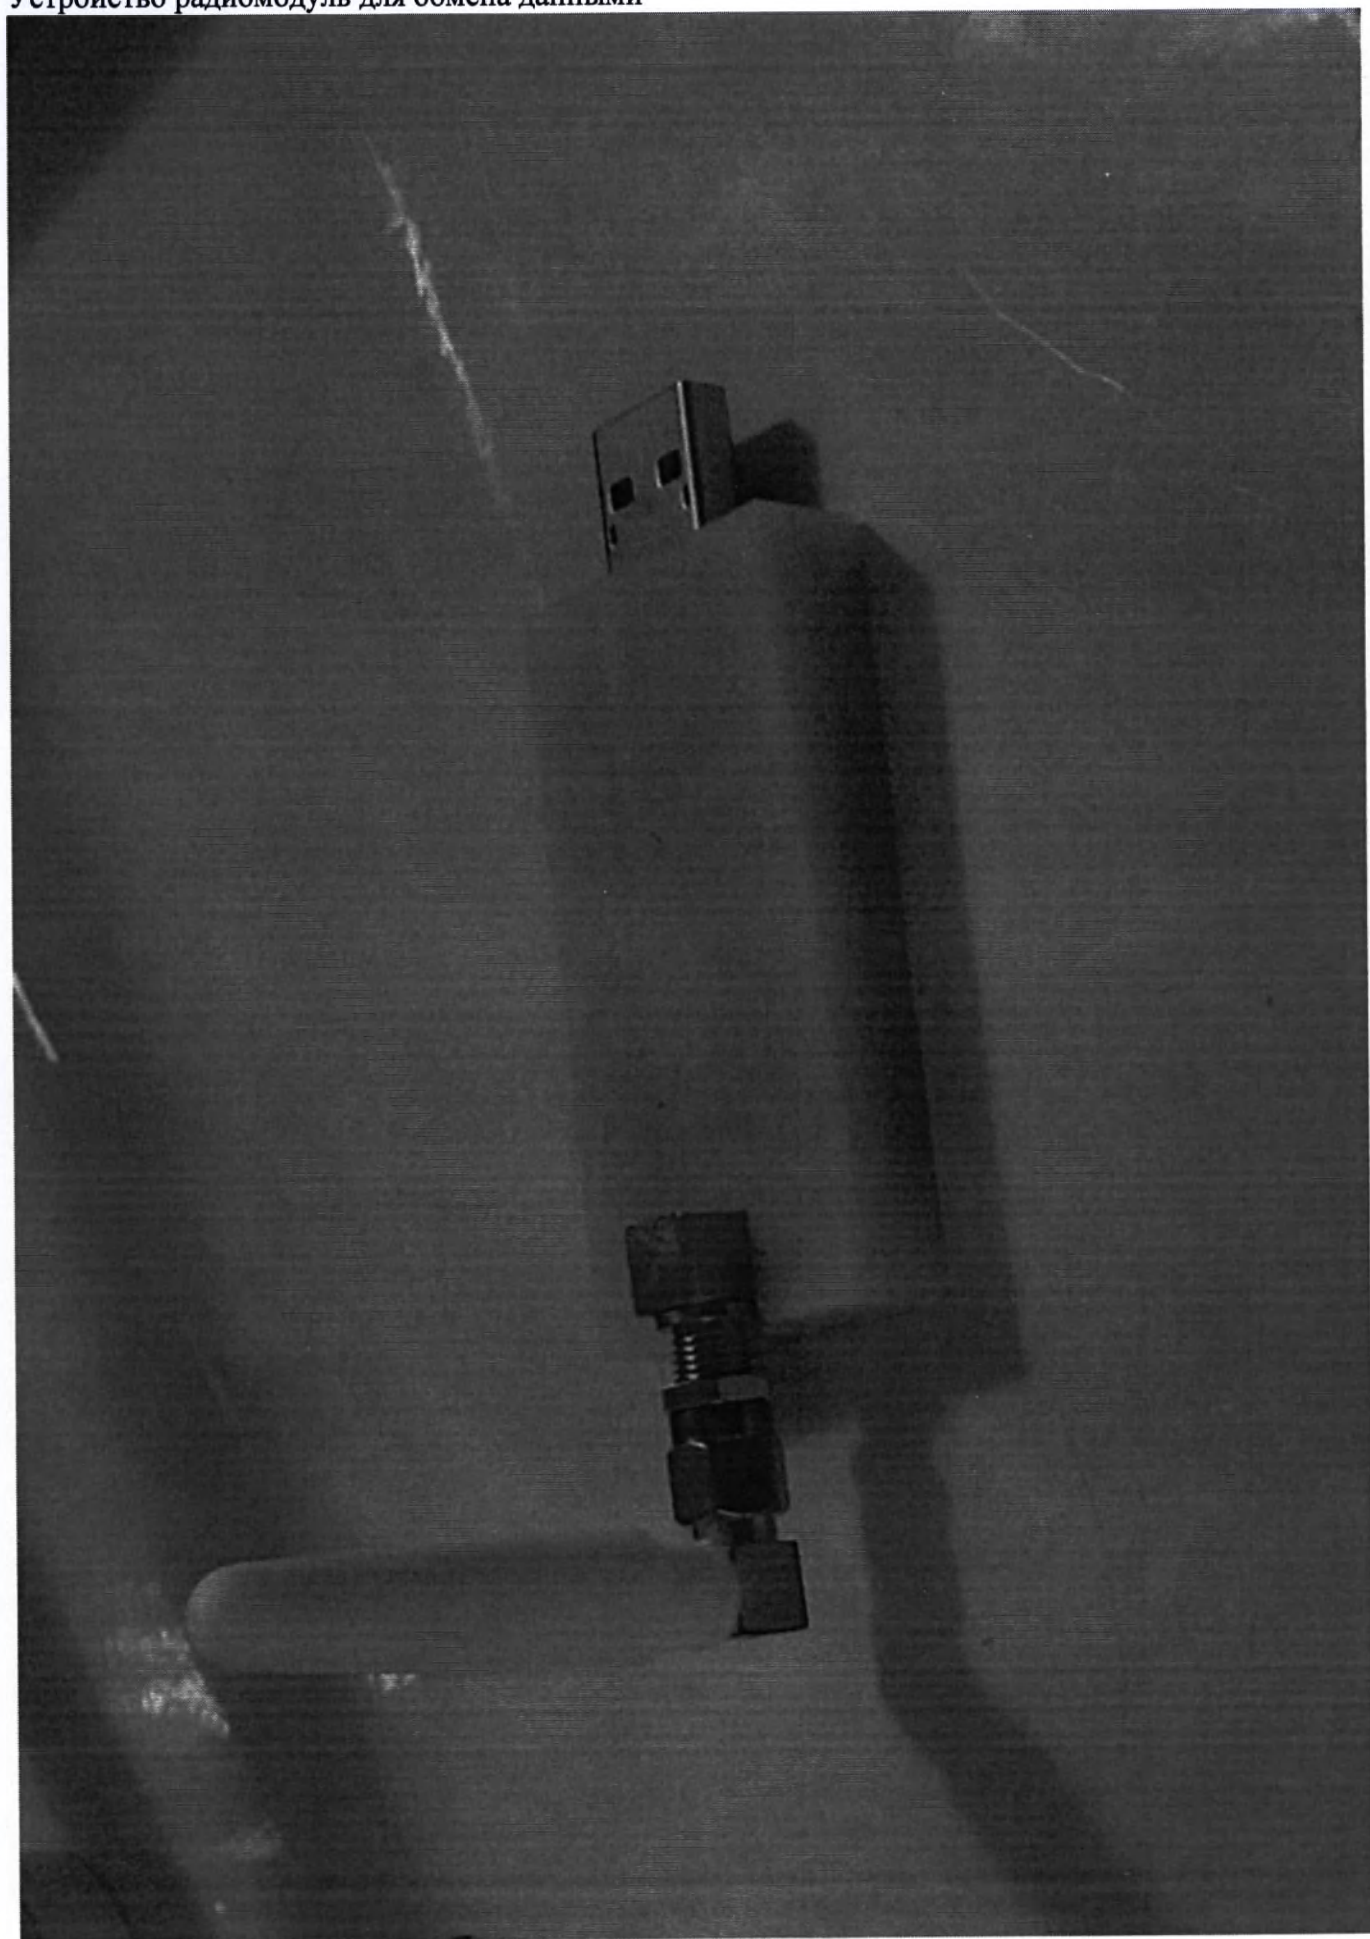


Протяжка (устройство перемещения катетера)

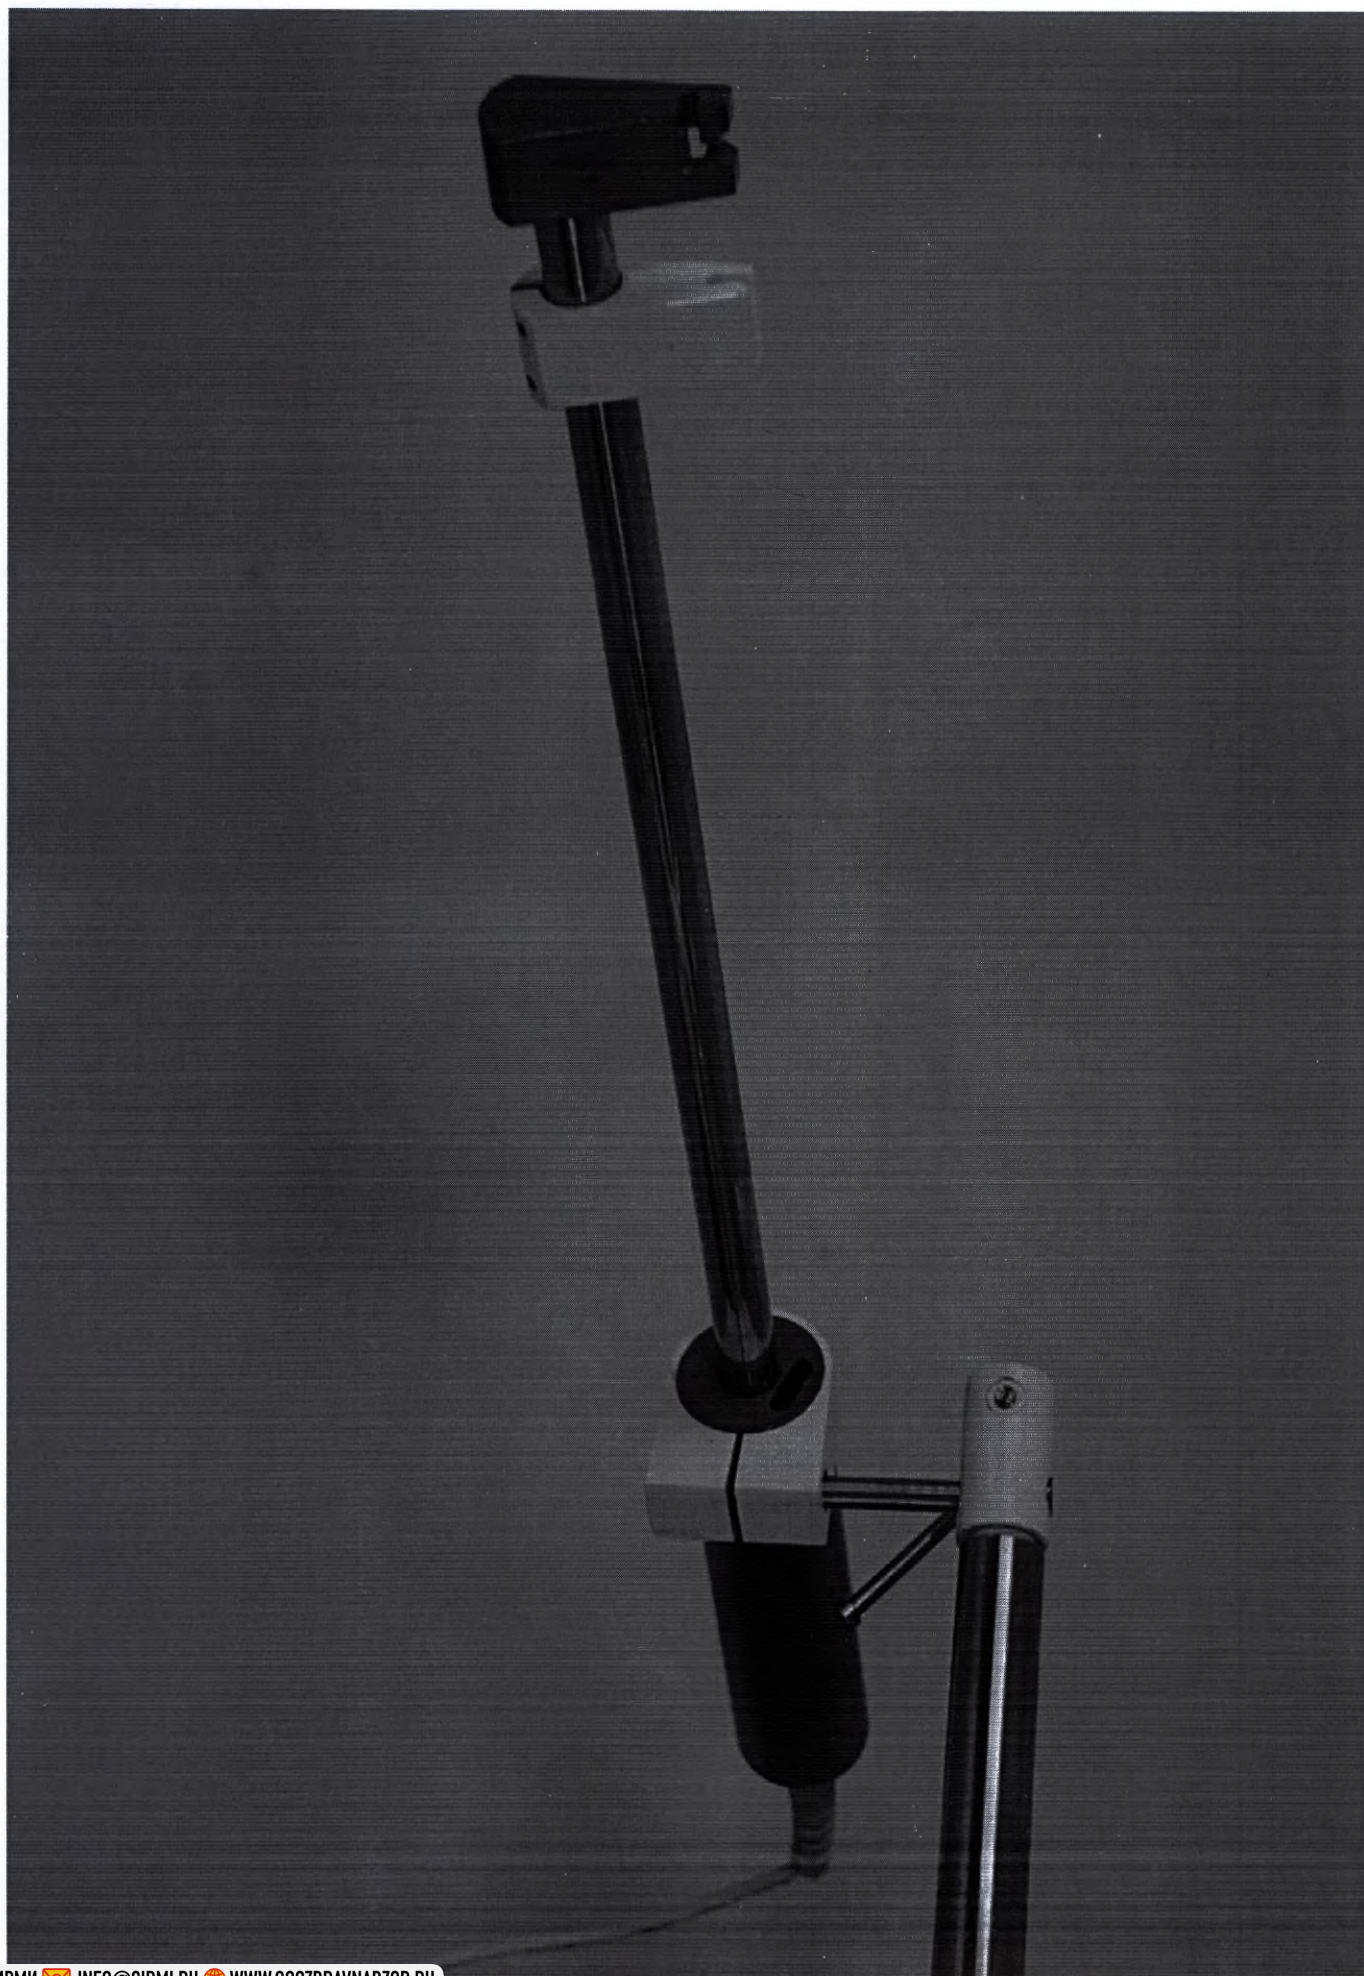





Воронка урофлоуметра

Отсекатель урофлоуметра

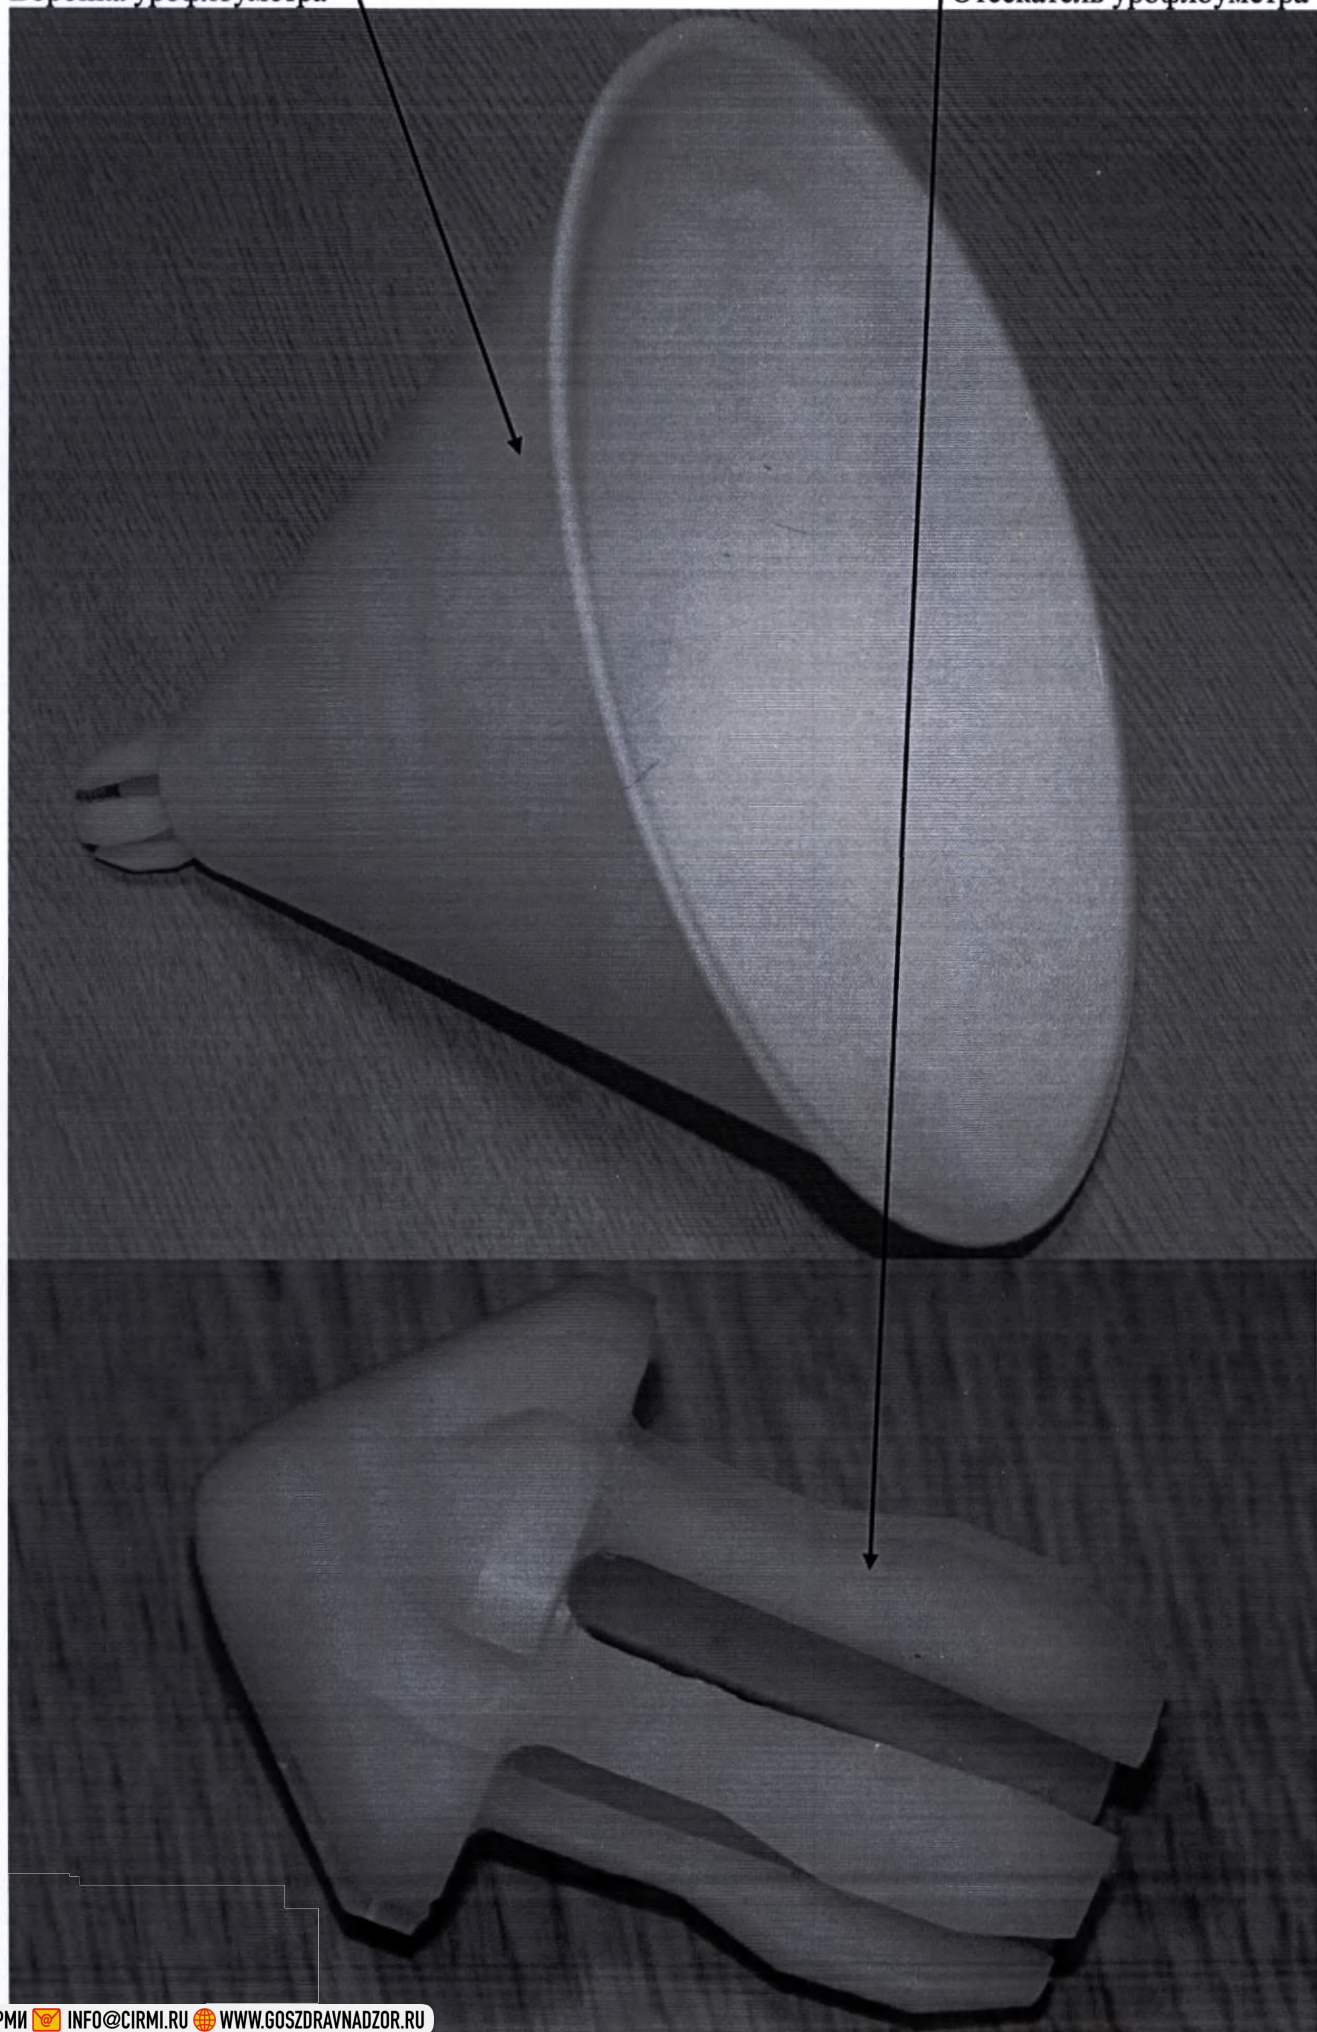


Сиденье урофлоуметра

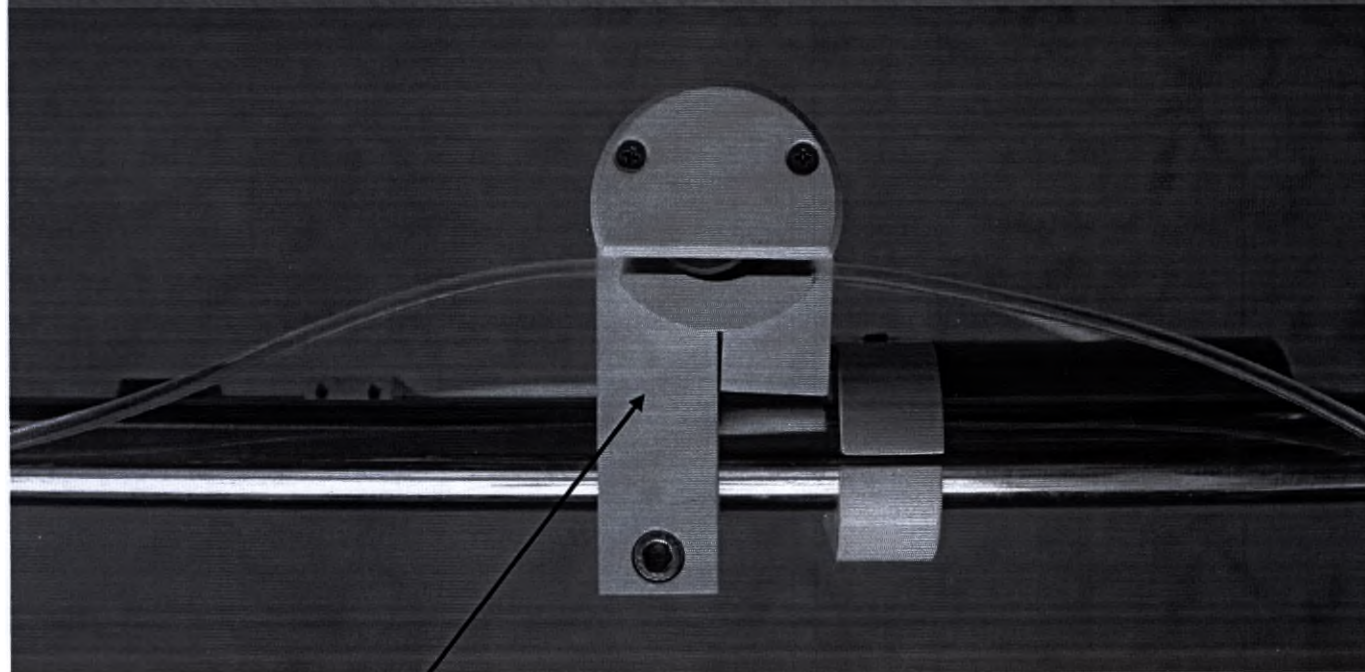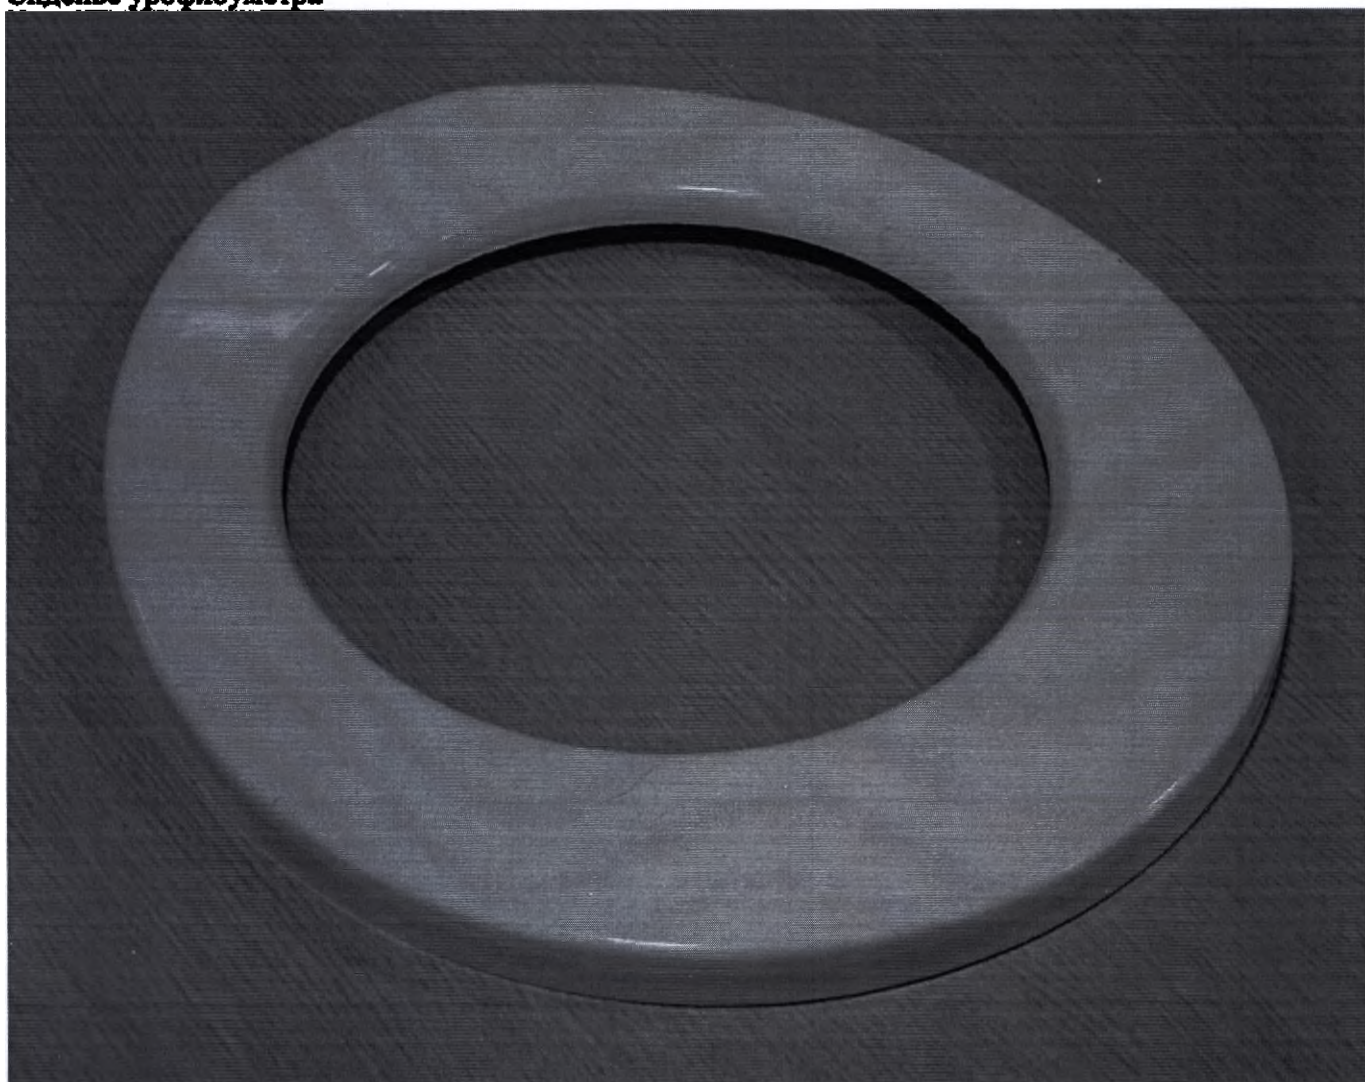


Микродозатор капельный на стойке УДС

Емкость для сбора мочи

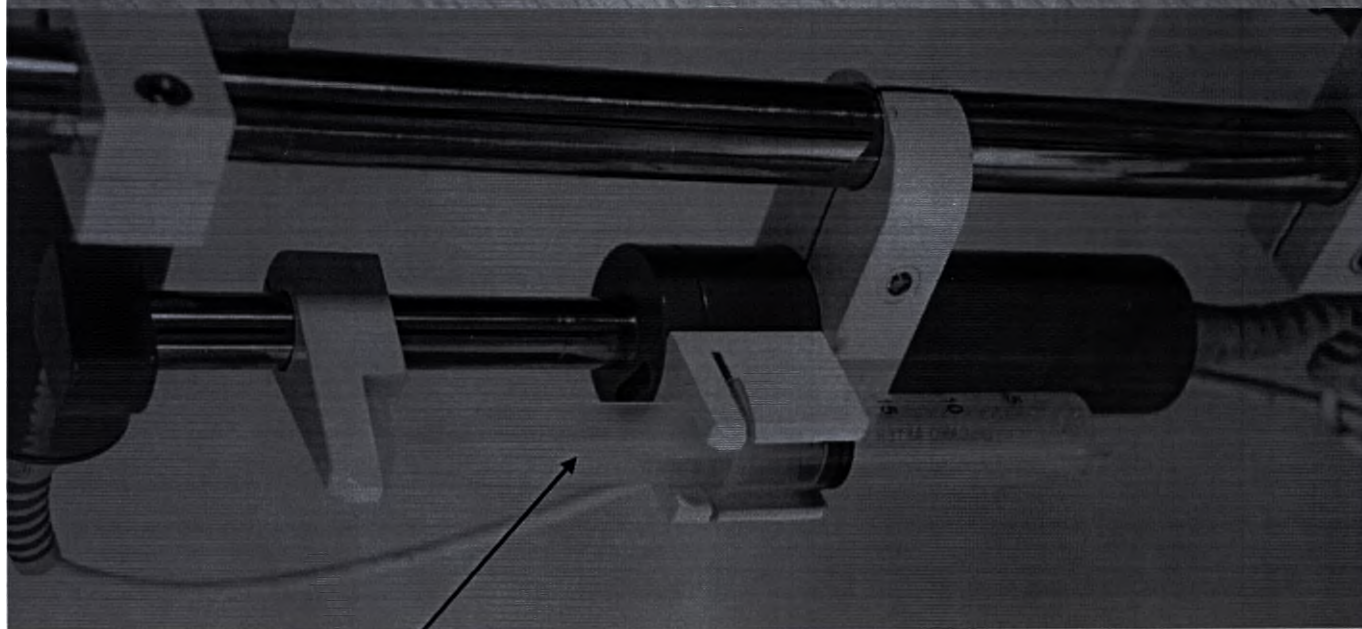


Микродозатор шприцевой на стойке УДС

Блок электромиографический внешний (ЭМГ)

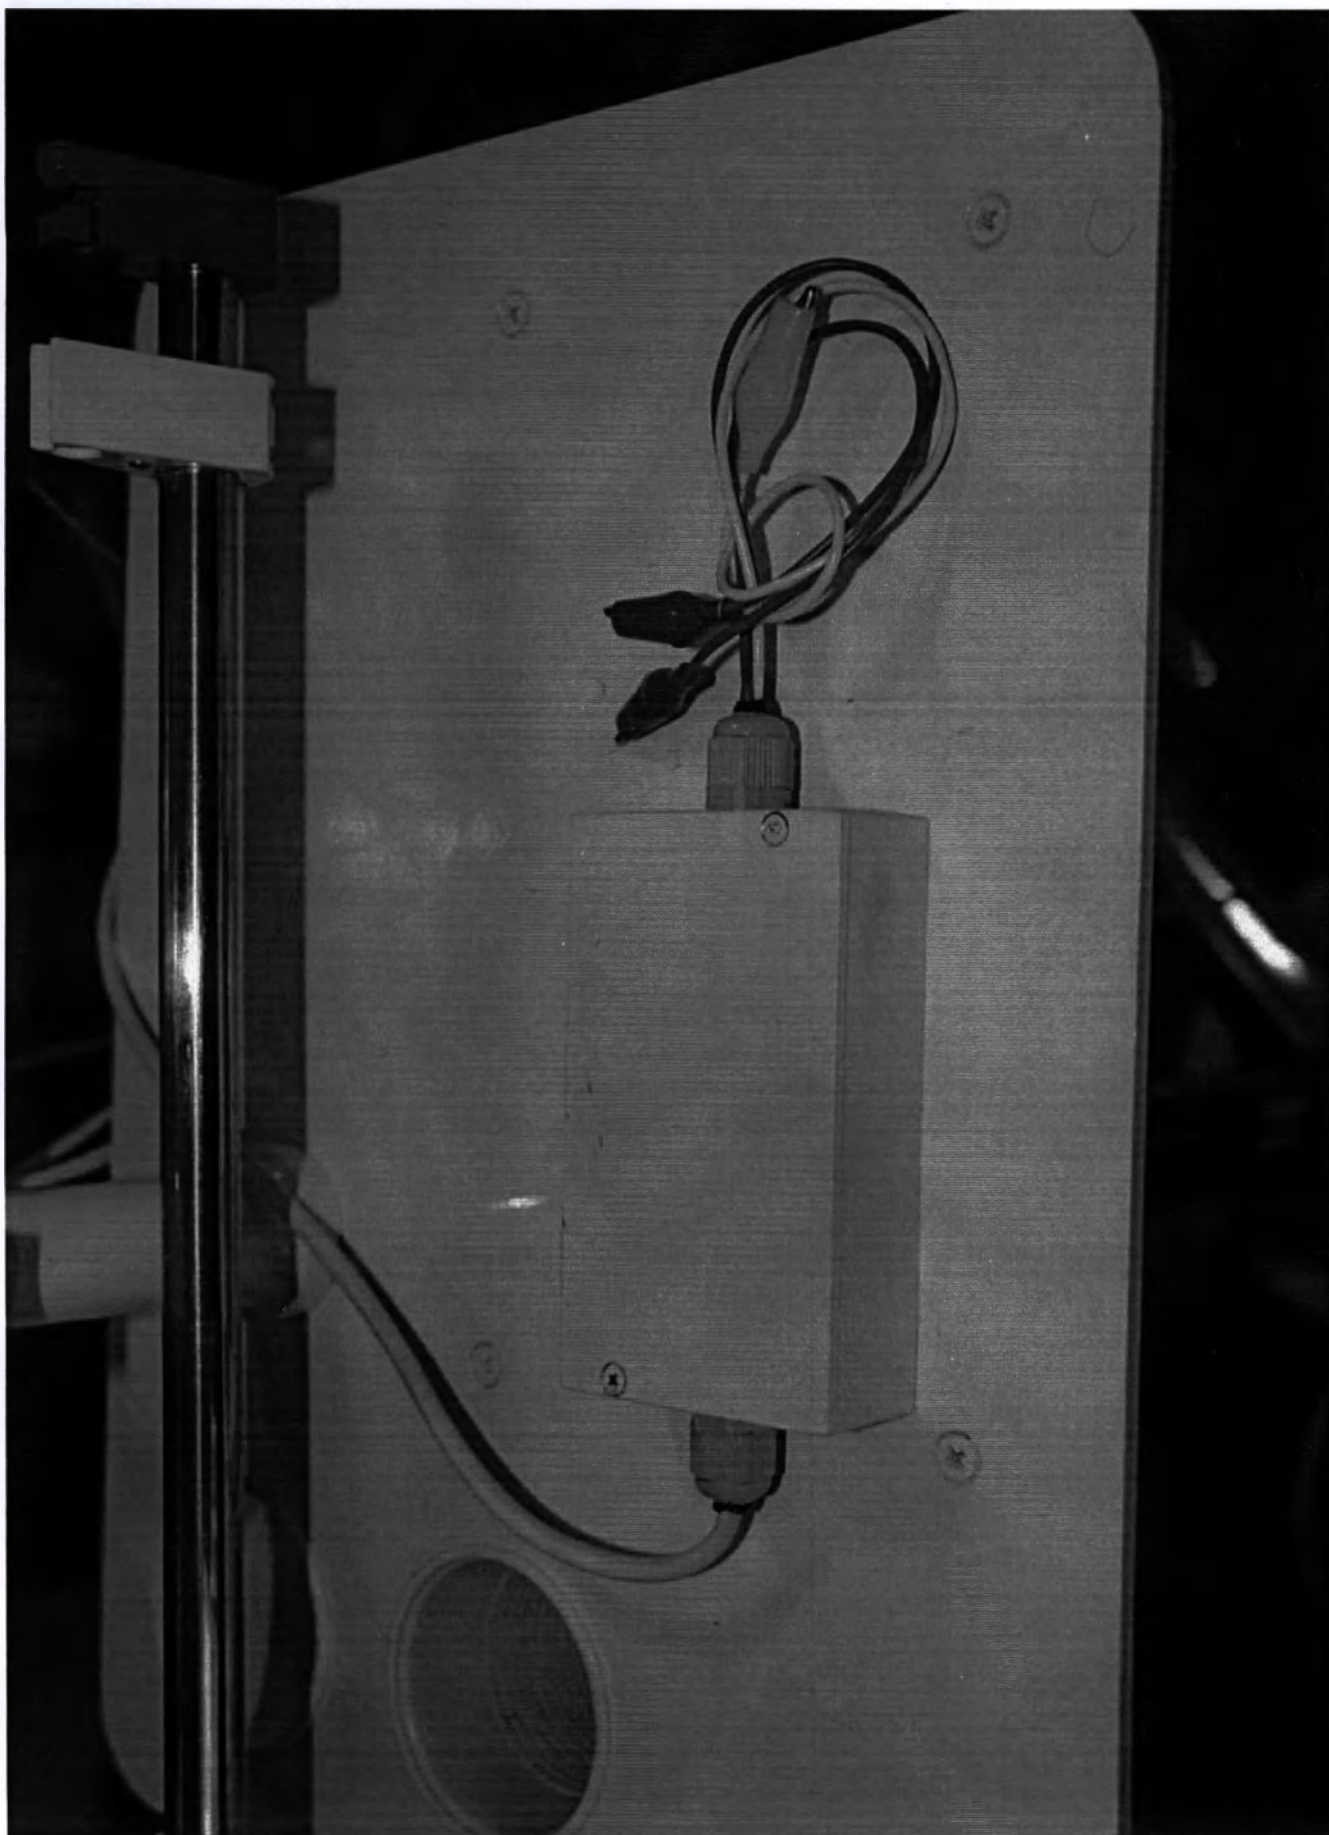


Блок весового датчика

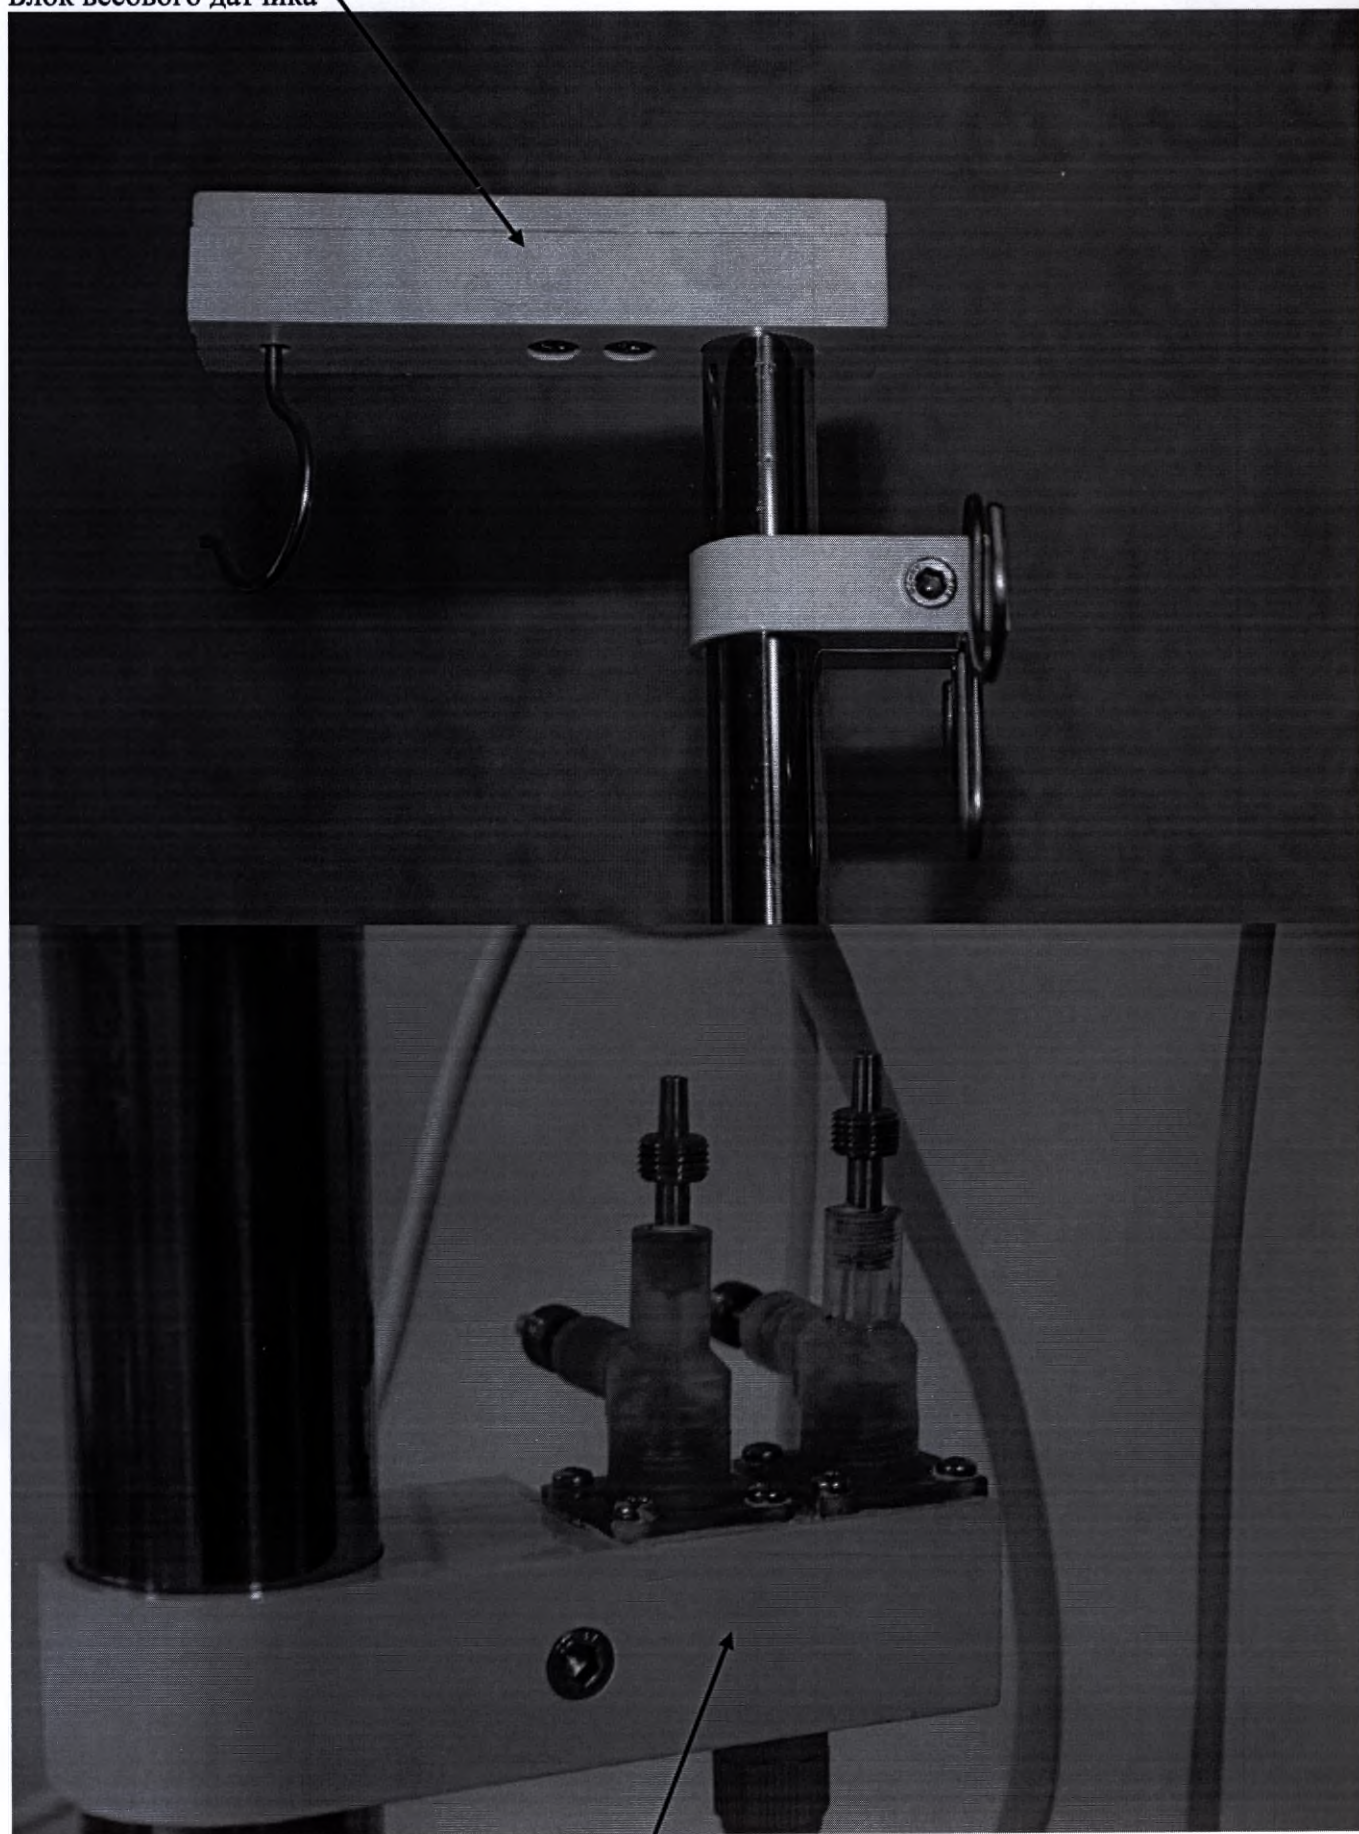

Блок манометров с 2 датчиками давления

Измерительная стойка (столик со встроенным измерительным блоком и блоком питания)

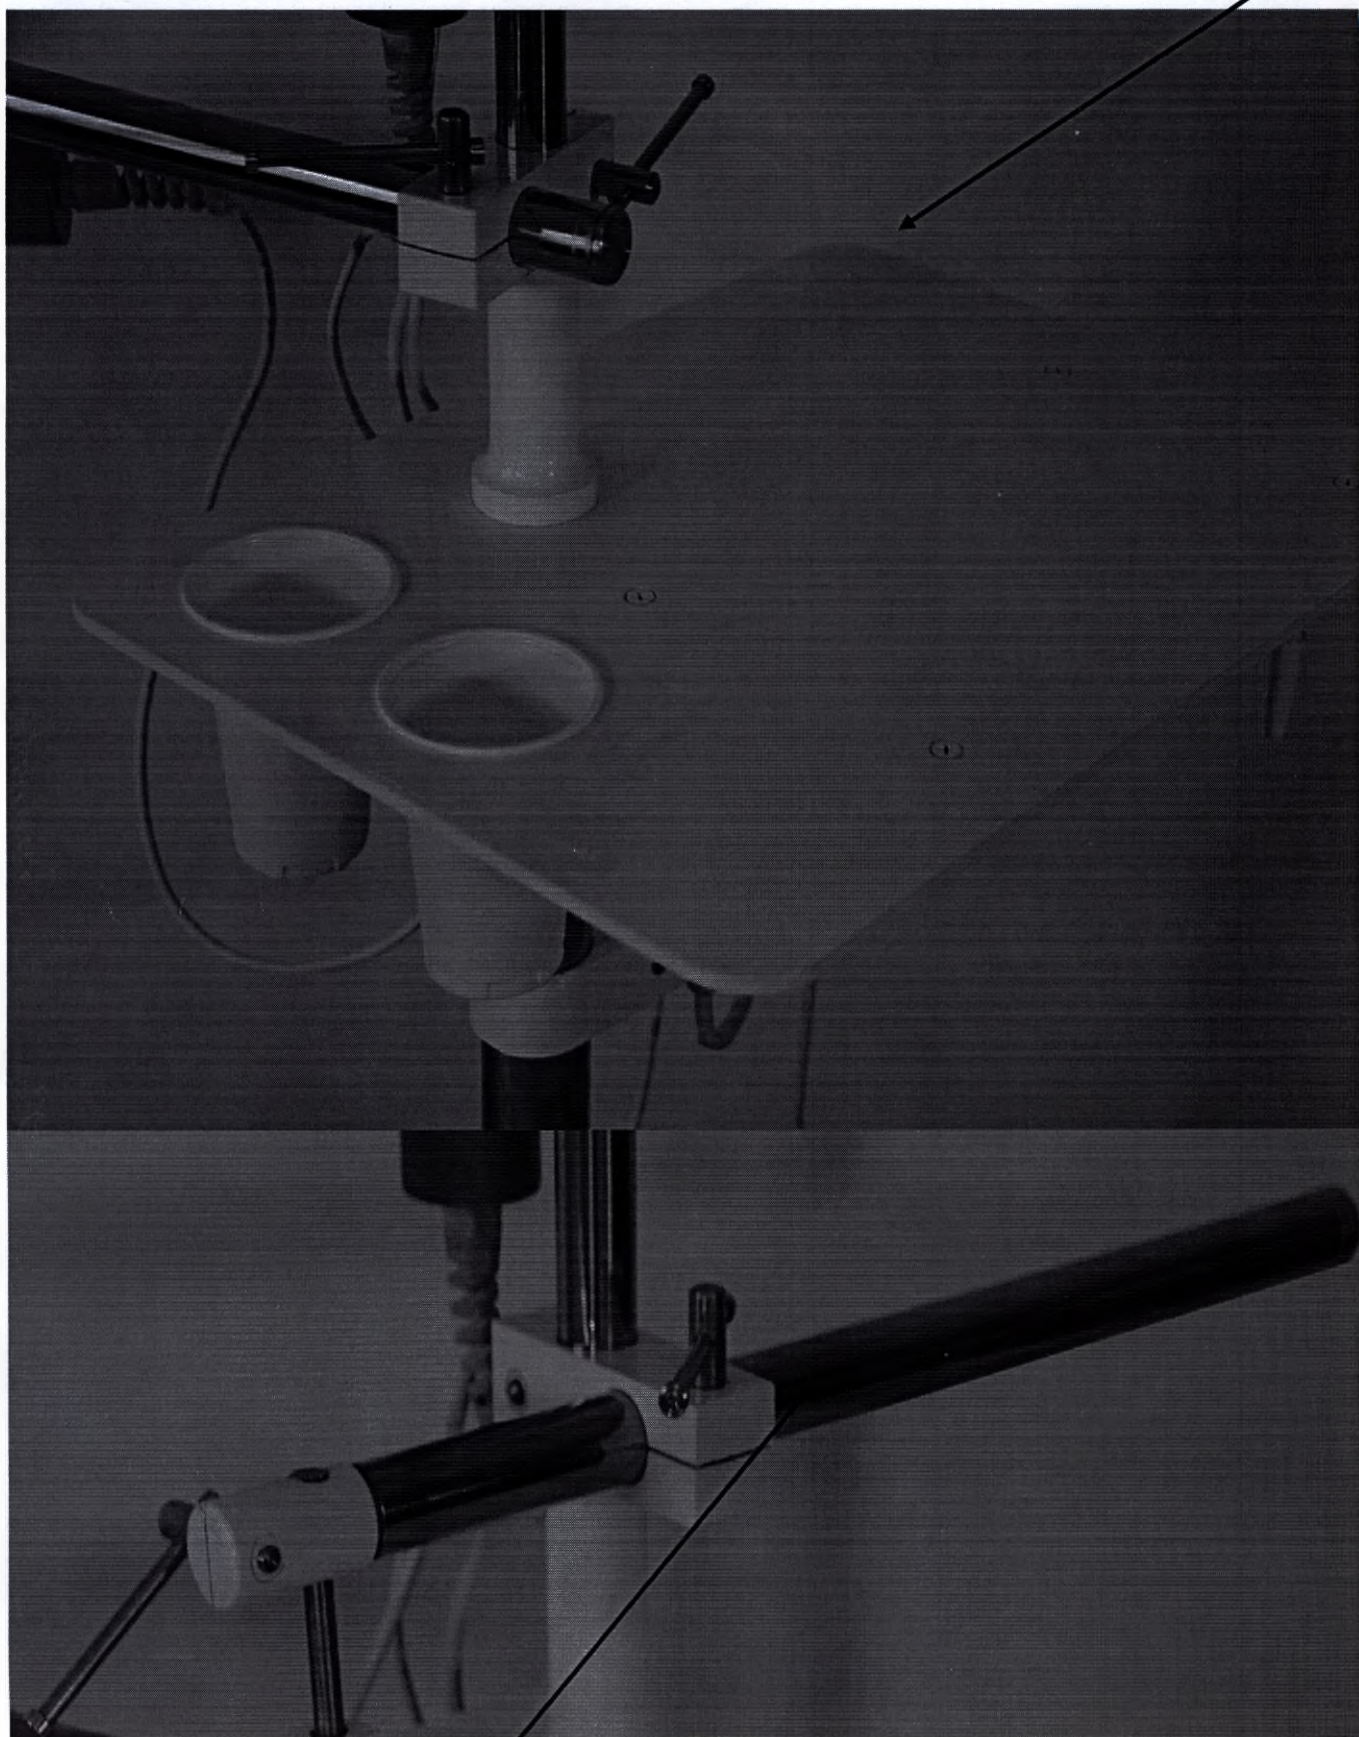

Штанга крепления протяжки

Счито и заверено печатью 11
(Одиннадцать) лист 06



Директор ООО «Уровест»
Данилов В.В.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Уровест»



В.В. Данилов

«01» октября 2021г.

Проект маркировки медицинского изделия

Маркировка

Маркировка УДС «АЛЬФА» должна содержать:

Товарный знак предприятия;

Наименование изделия;

Номер изделия;

Год выпуска;

Знак подтверждения соответствия (при наличии)

Обозначение настоящих технических условий

Параметры питающей сети

Степень защиты от поражения электрическим током

Степень защиты от влаги

Значение потребляемой мощности



Уродинамическая система «АЛЬФА»

001 год выпуска 2020

УДС 0012 002 00645407 2020

УДС 0012 002 00645407 2020

Питание ~ 220 В 50Гц 20 Вт



Сшито и заверено печатью 3
(три) листа а



Директор ООО «Уровест»
Данилов В.В.