

Фотографические изображения медицинского изделия
«Петля Optimos для полипэктомии»,
производства «Таэвоонг Медикал Ко., Лтд», Корея
«Taewoong Medical Co., Ltd.», 14 Gojeong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea.

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16RN-10




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-10 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-10 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23RN-10

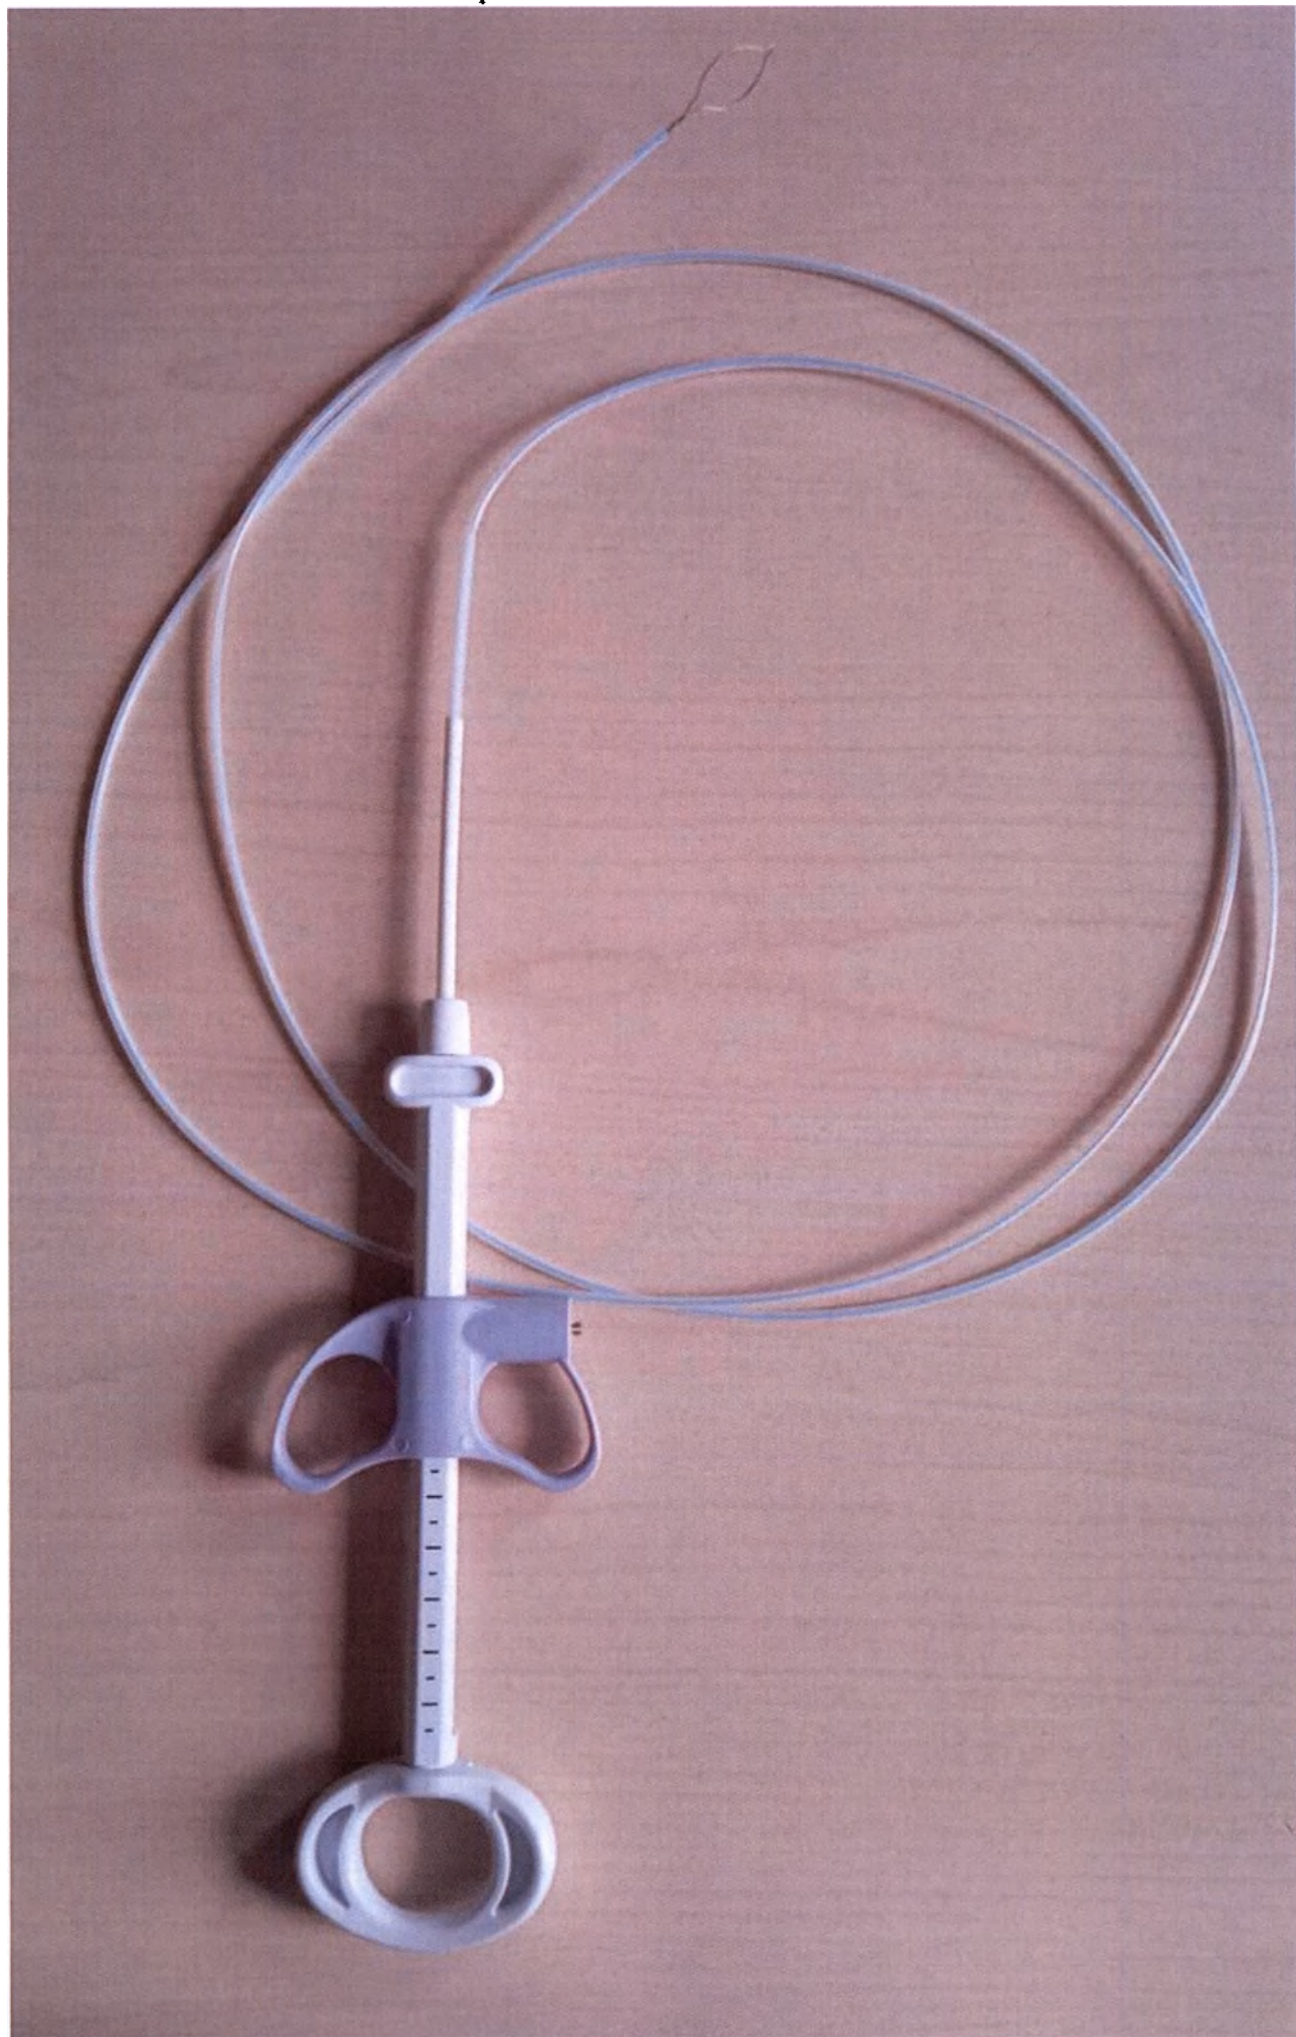

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-10 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-10 (во вторичной упаковке)




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16RN-15



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-15 (в первичной упаковке)





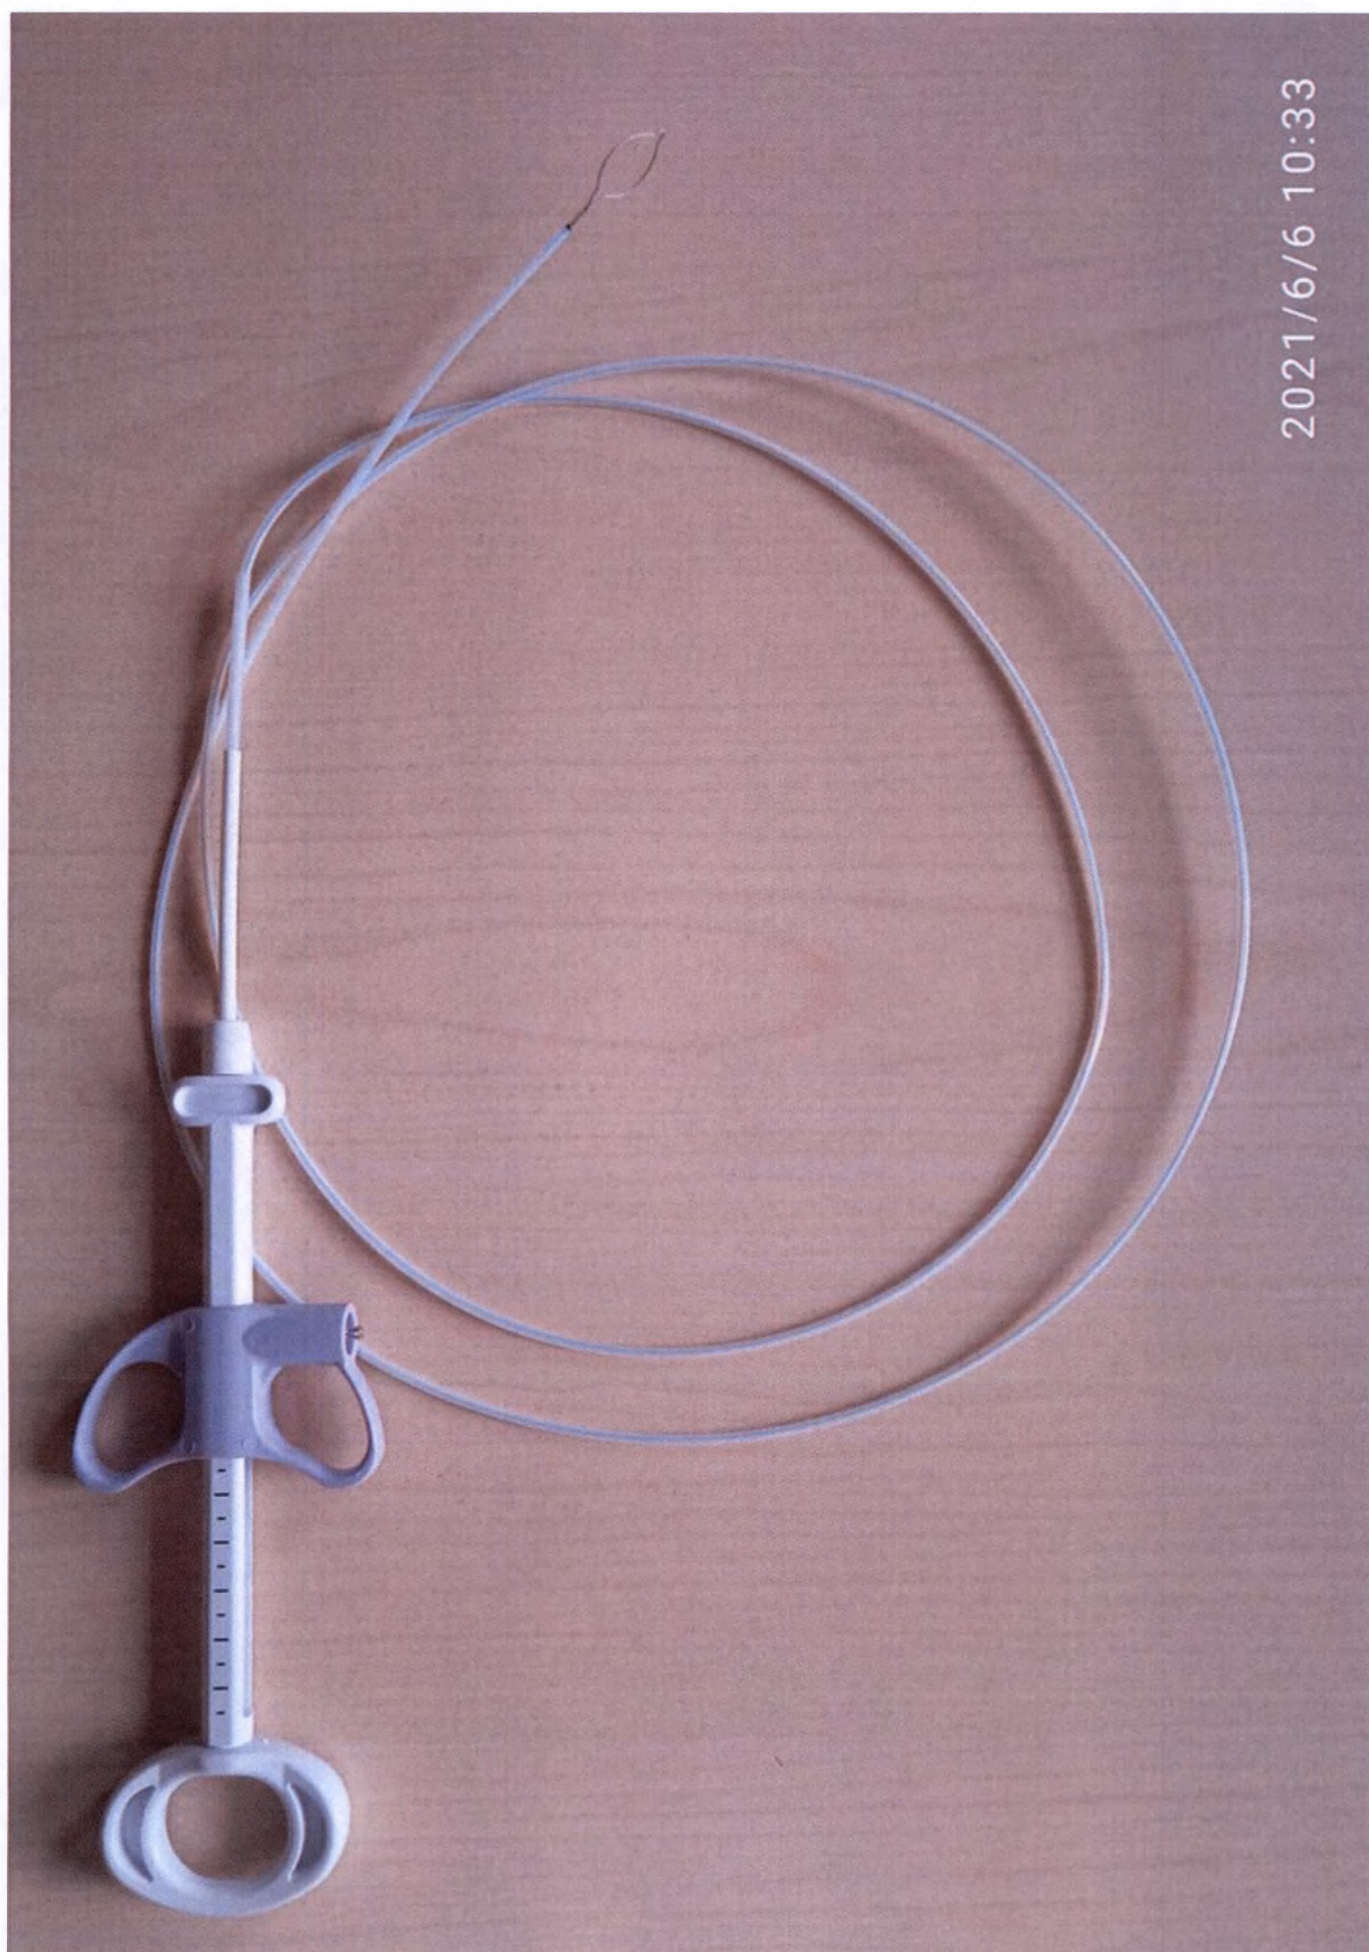

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-15 (в первичной упаковке)




2021/6/6 10:31

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-15 (во вторичной упаковке)



知

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16RN-20

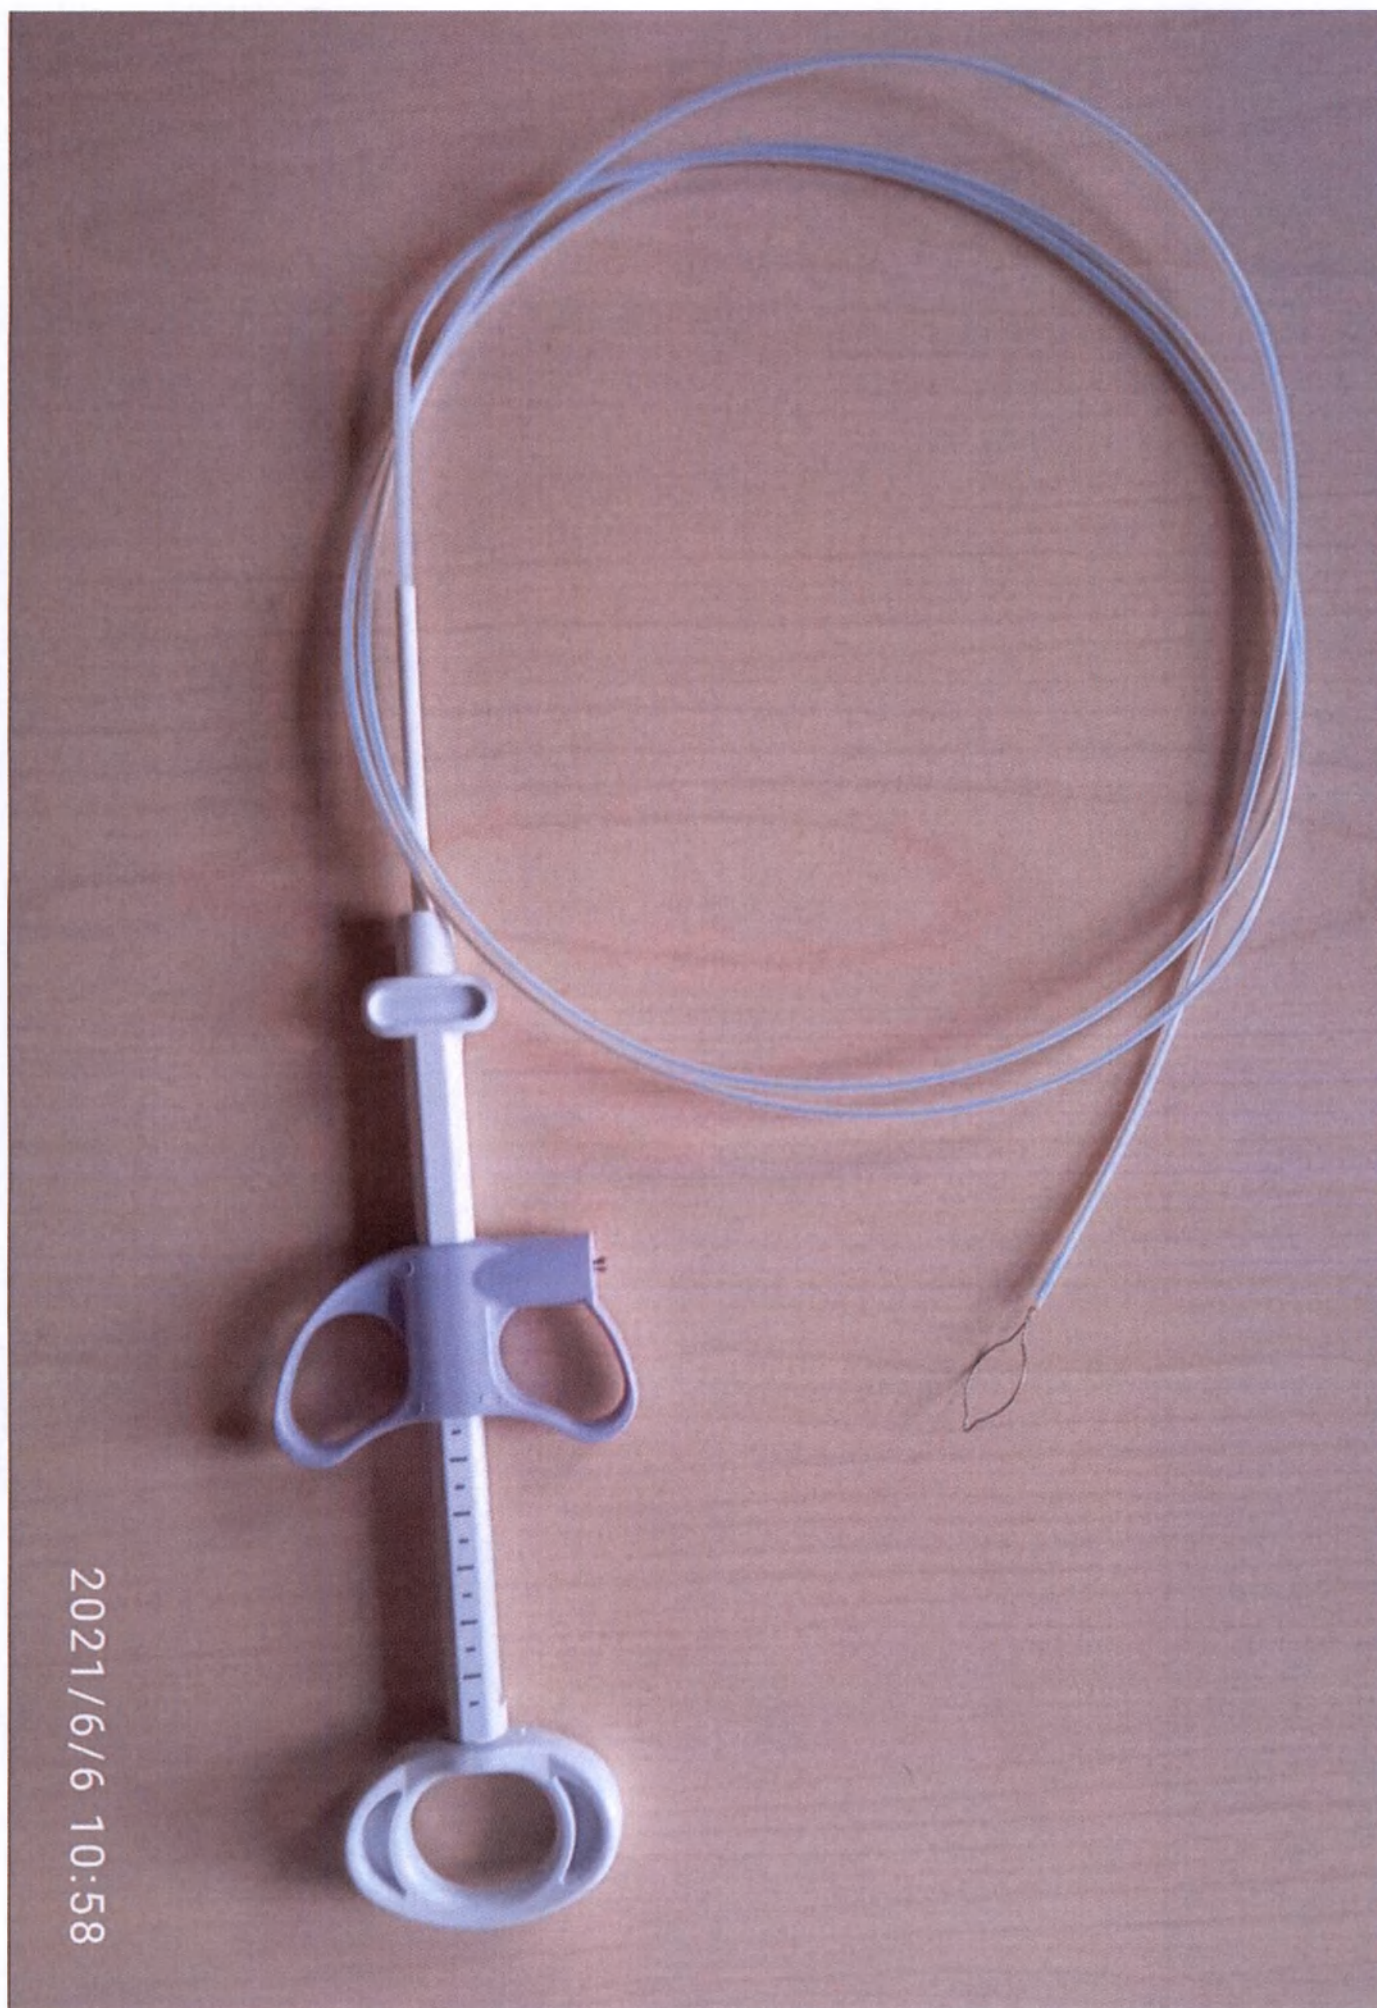


2021/6/6 10:58


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-20 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-20 (во вторичной упаковке)

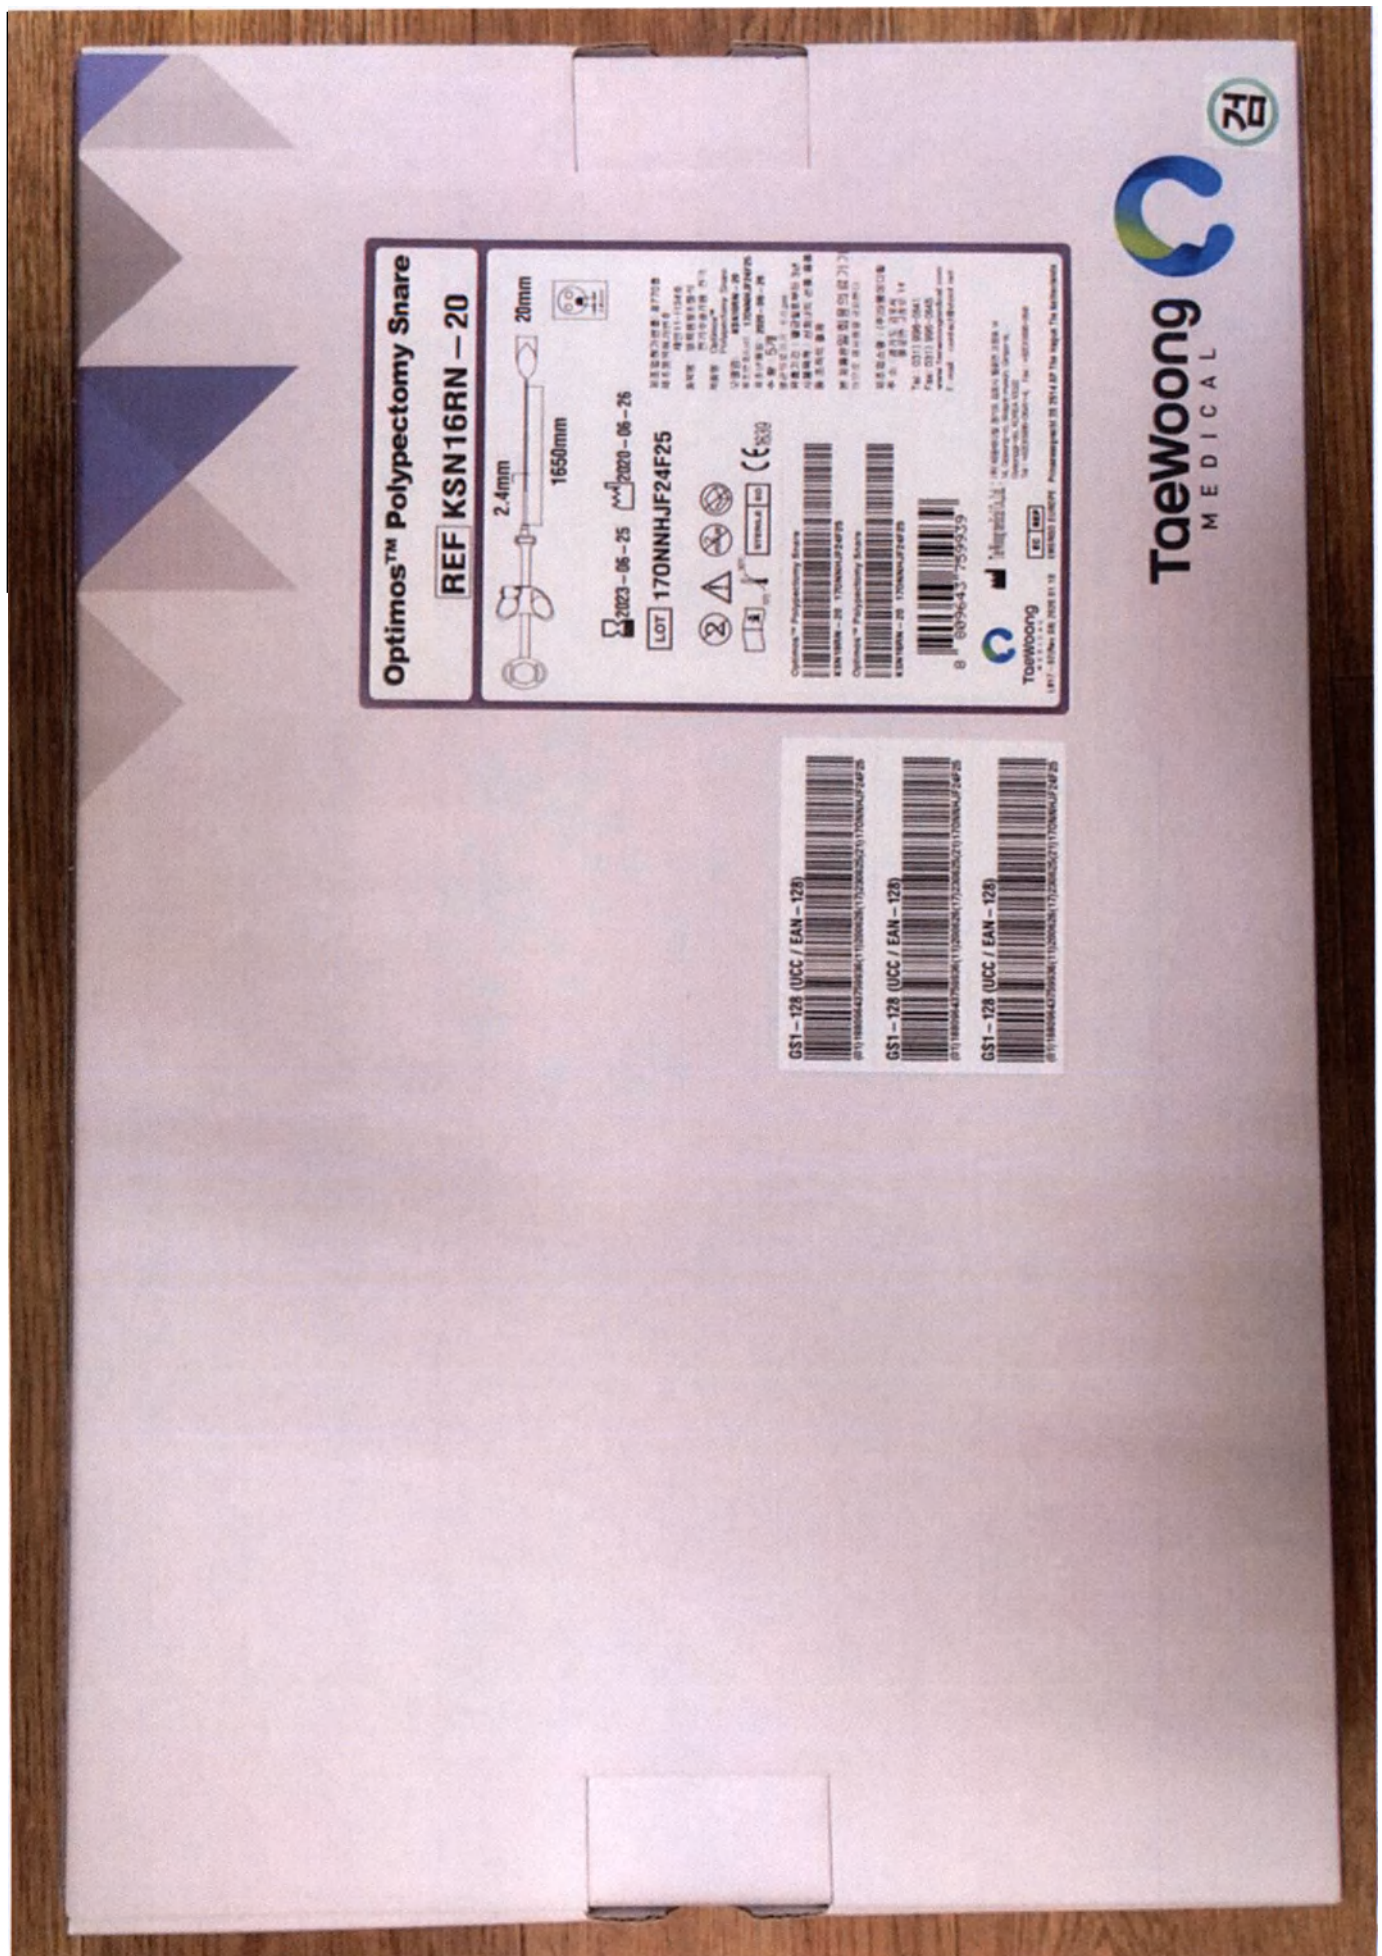

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23RN-20

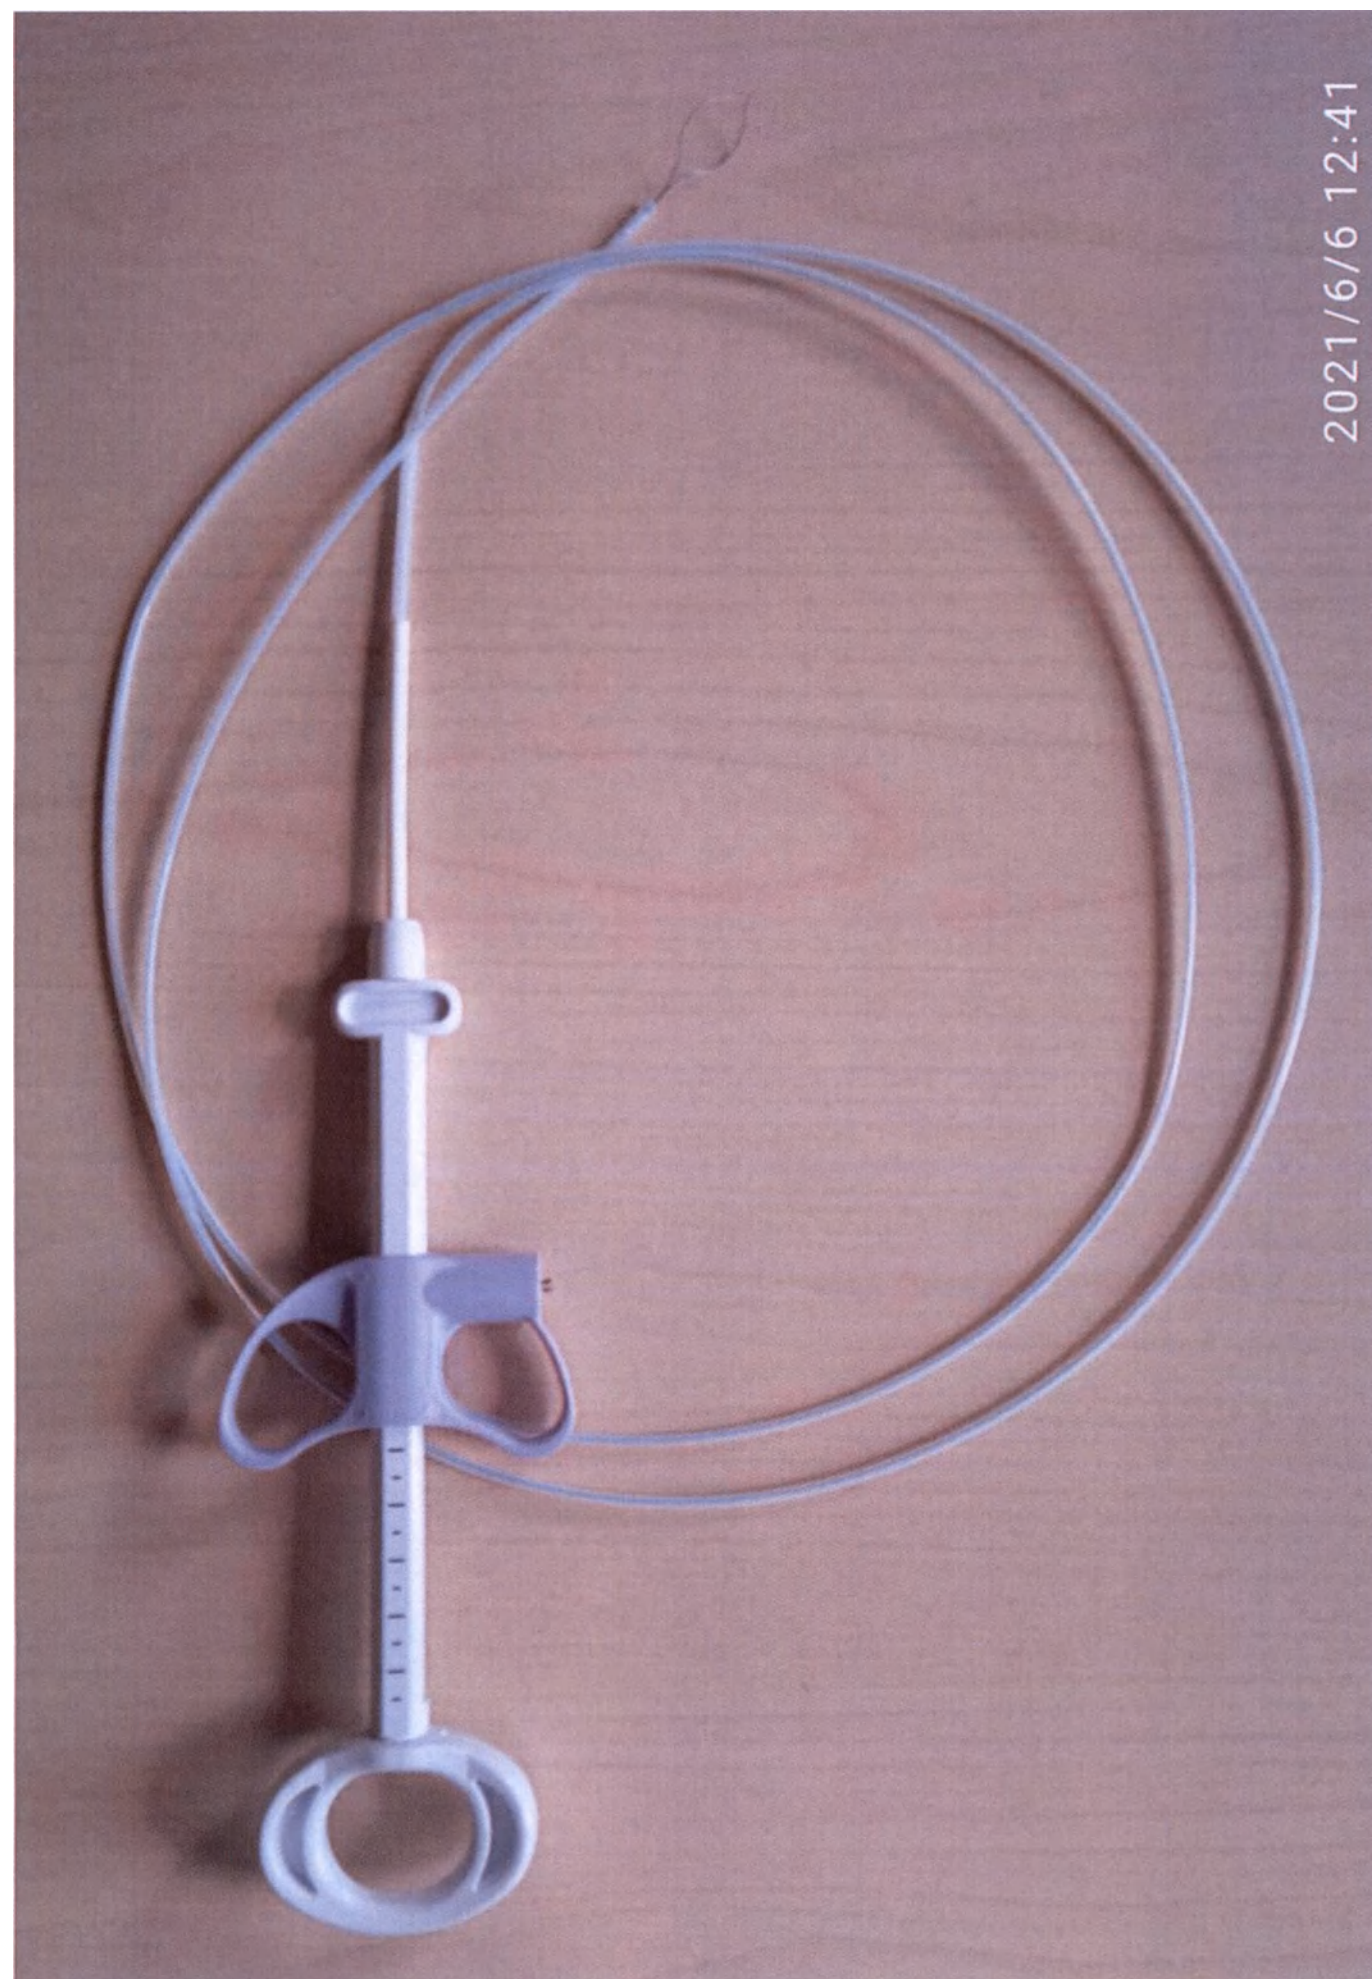

2021/6/6 12:41


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-20 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-20 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-25

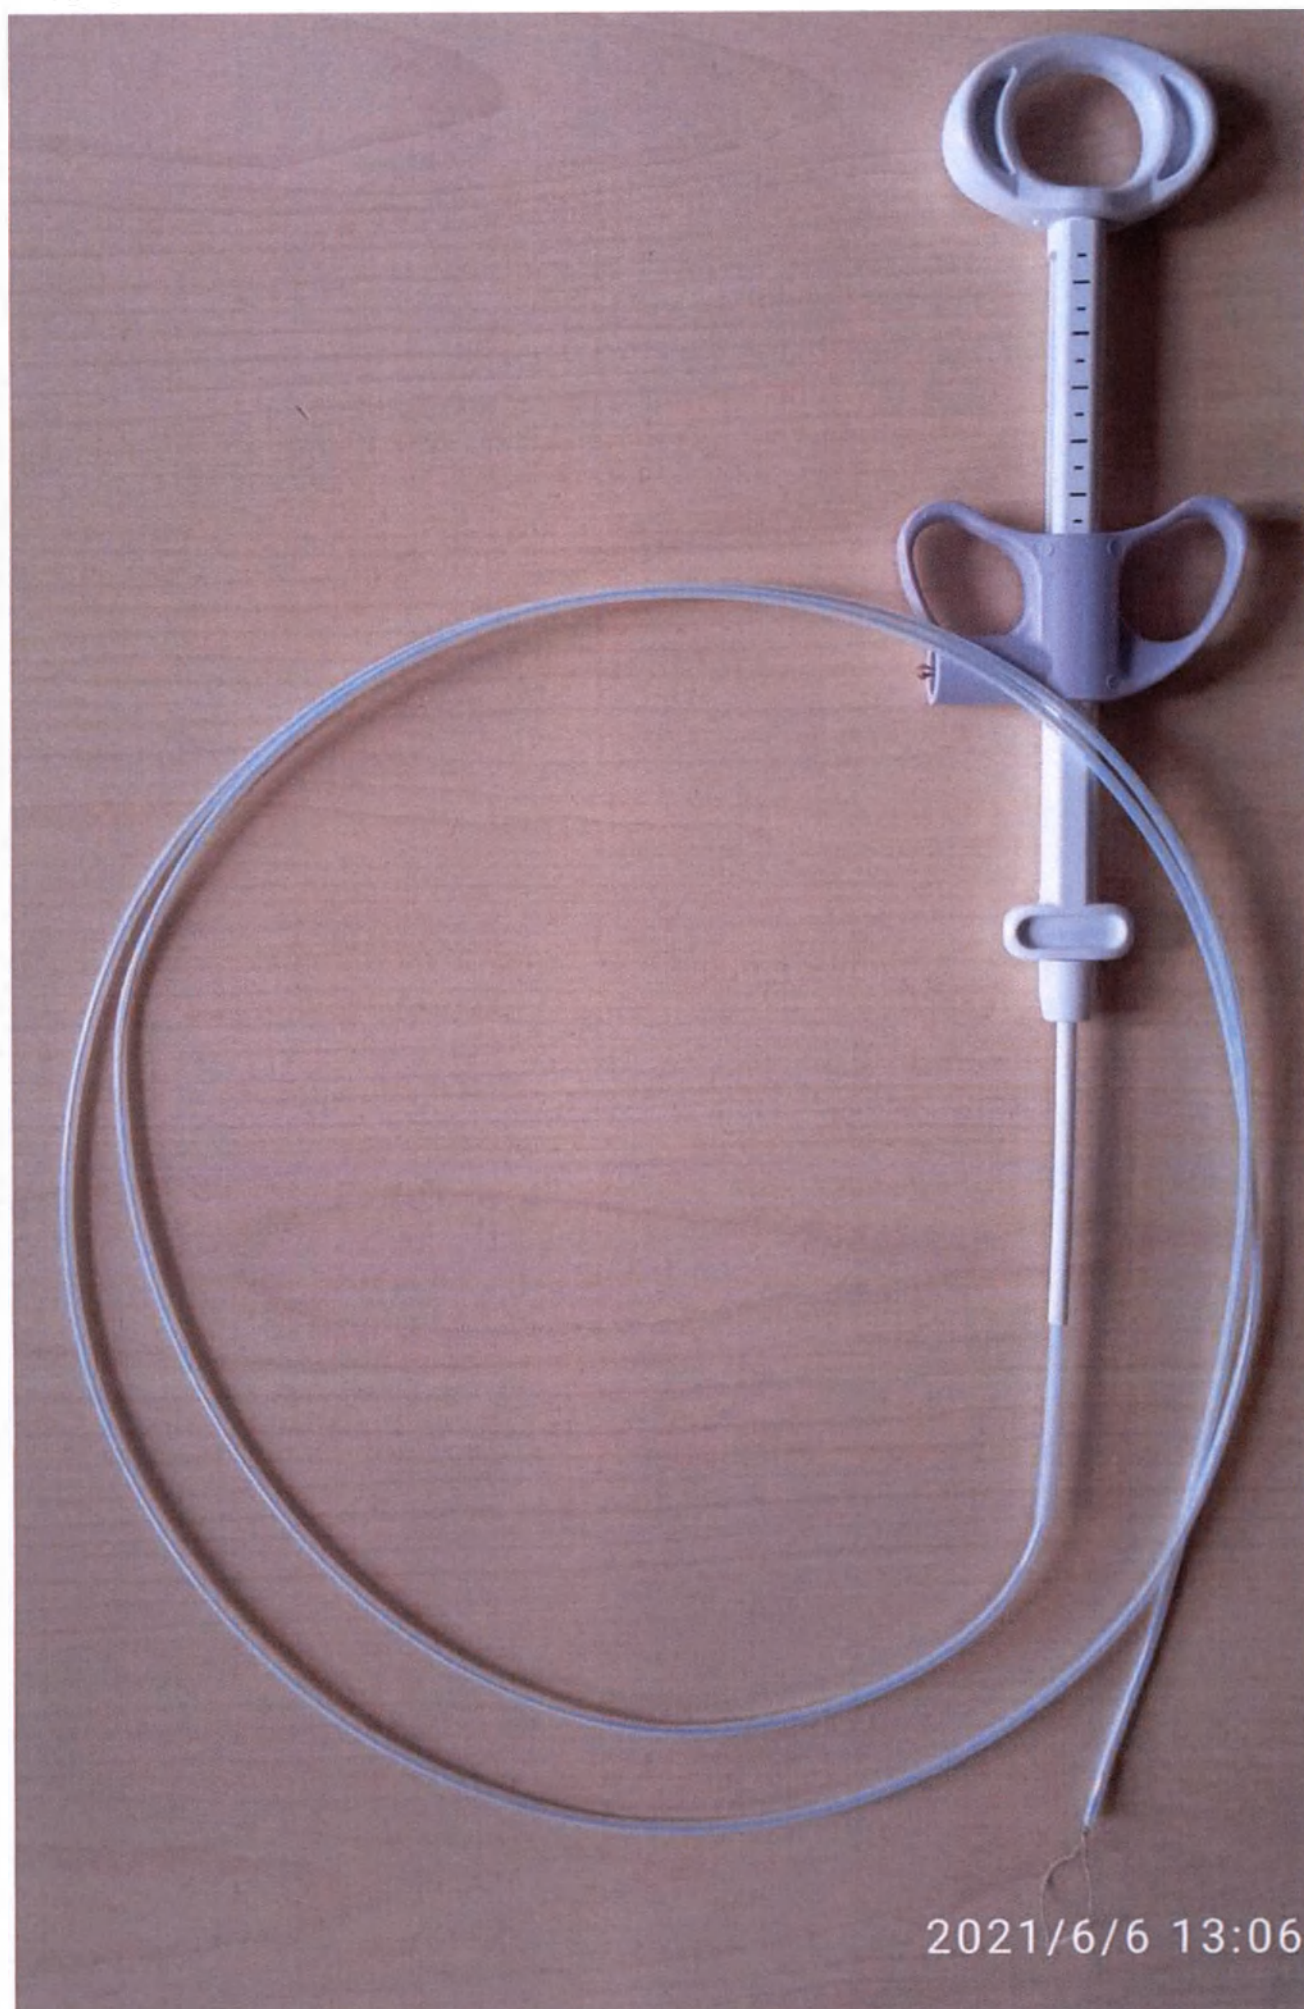

2021/6/6 13:06

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-25 (в первичной упаковке)

2021/6/6 13:05



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-25(во вторичной упаковке)

Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN16RN - 25

2023-06-25 2020-06-26

LOT 170NNIJF24F25

CE 8339

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN16RN-25 170NNIJF24F25

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN16RN-25 170NNIJF24F25

8 809253 8339602

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)


170NNIJF24F25

170NNIJF24F25

170NNIJF24F25



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23RN-25

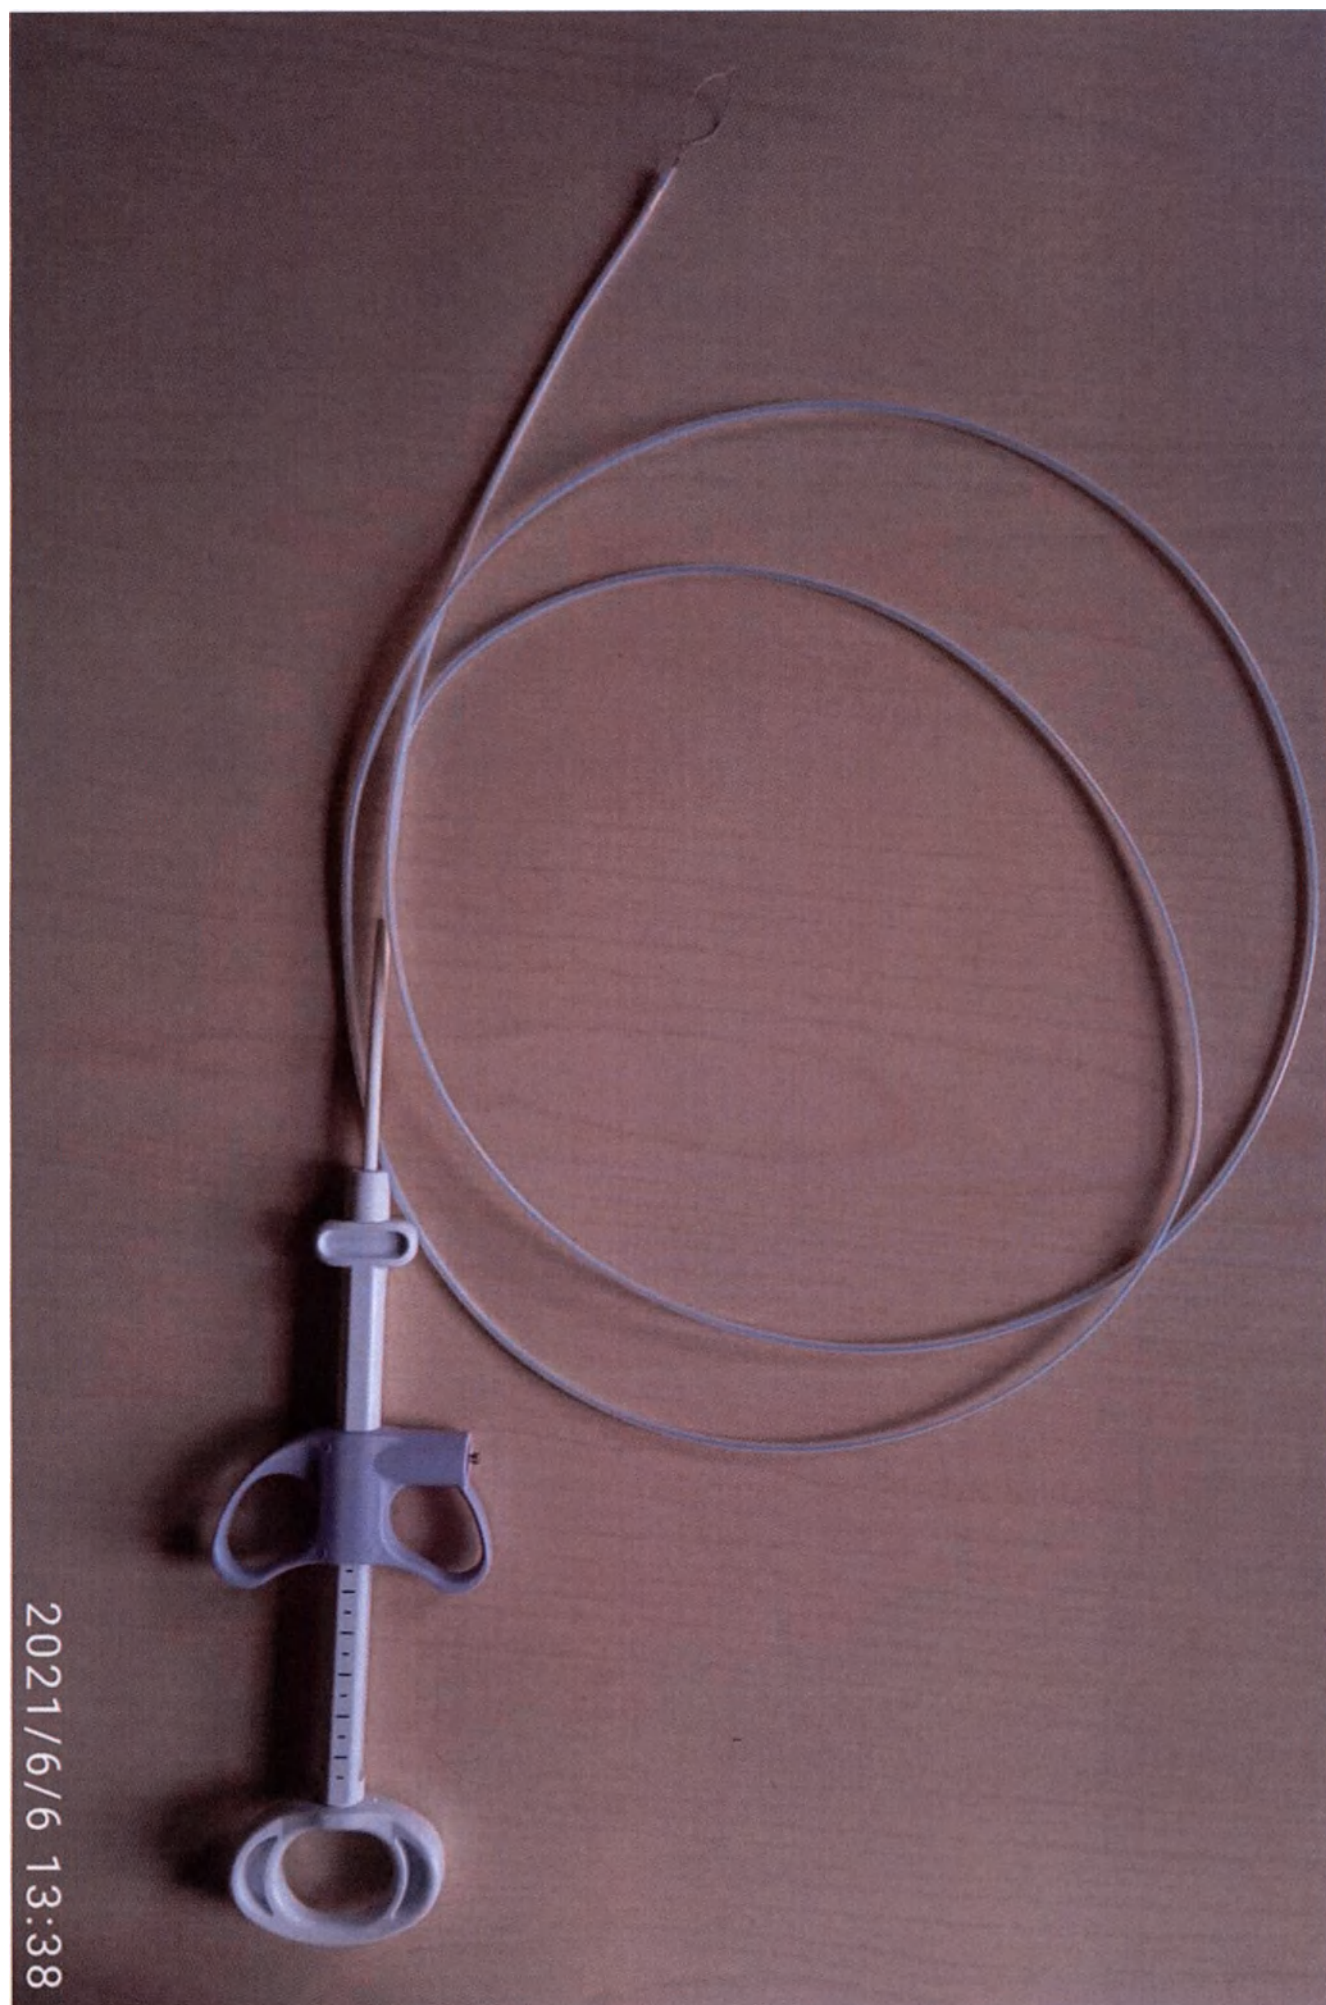


2021/6/6 13:38

2021/6/6 13:37




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16RN-30

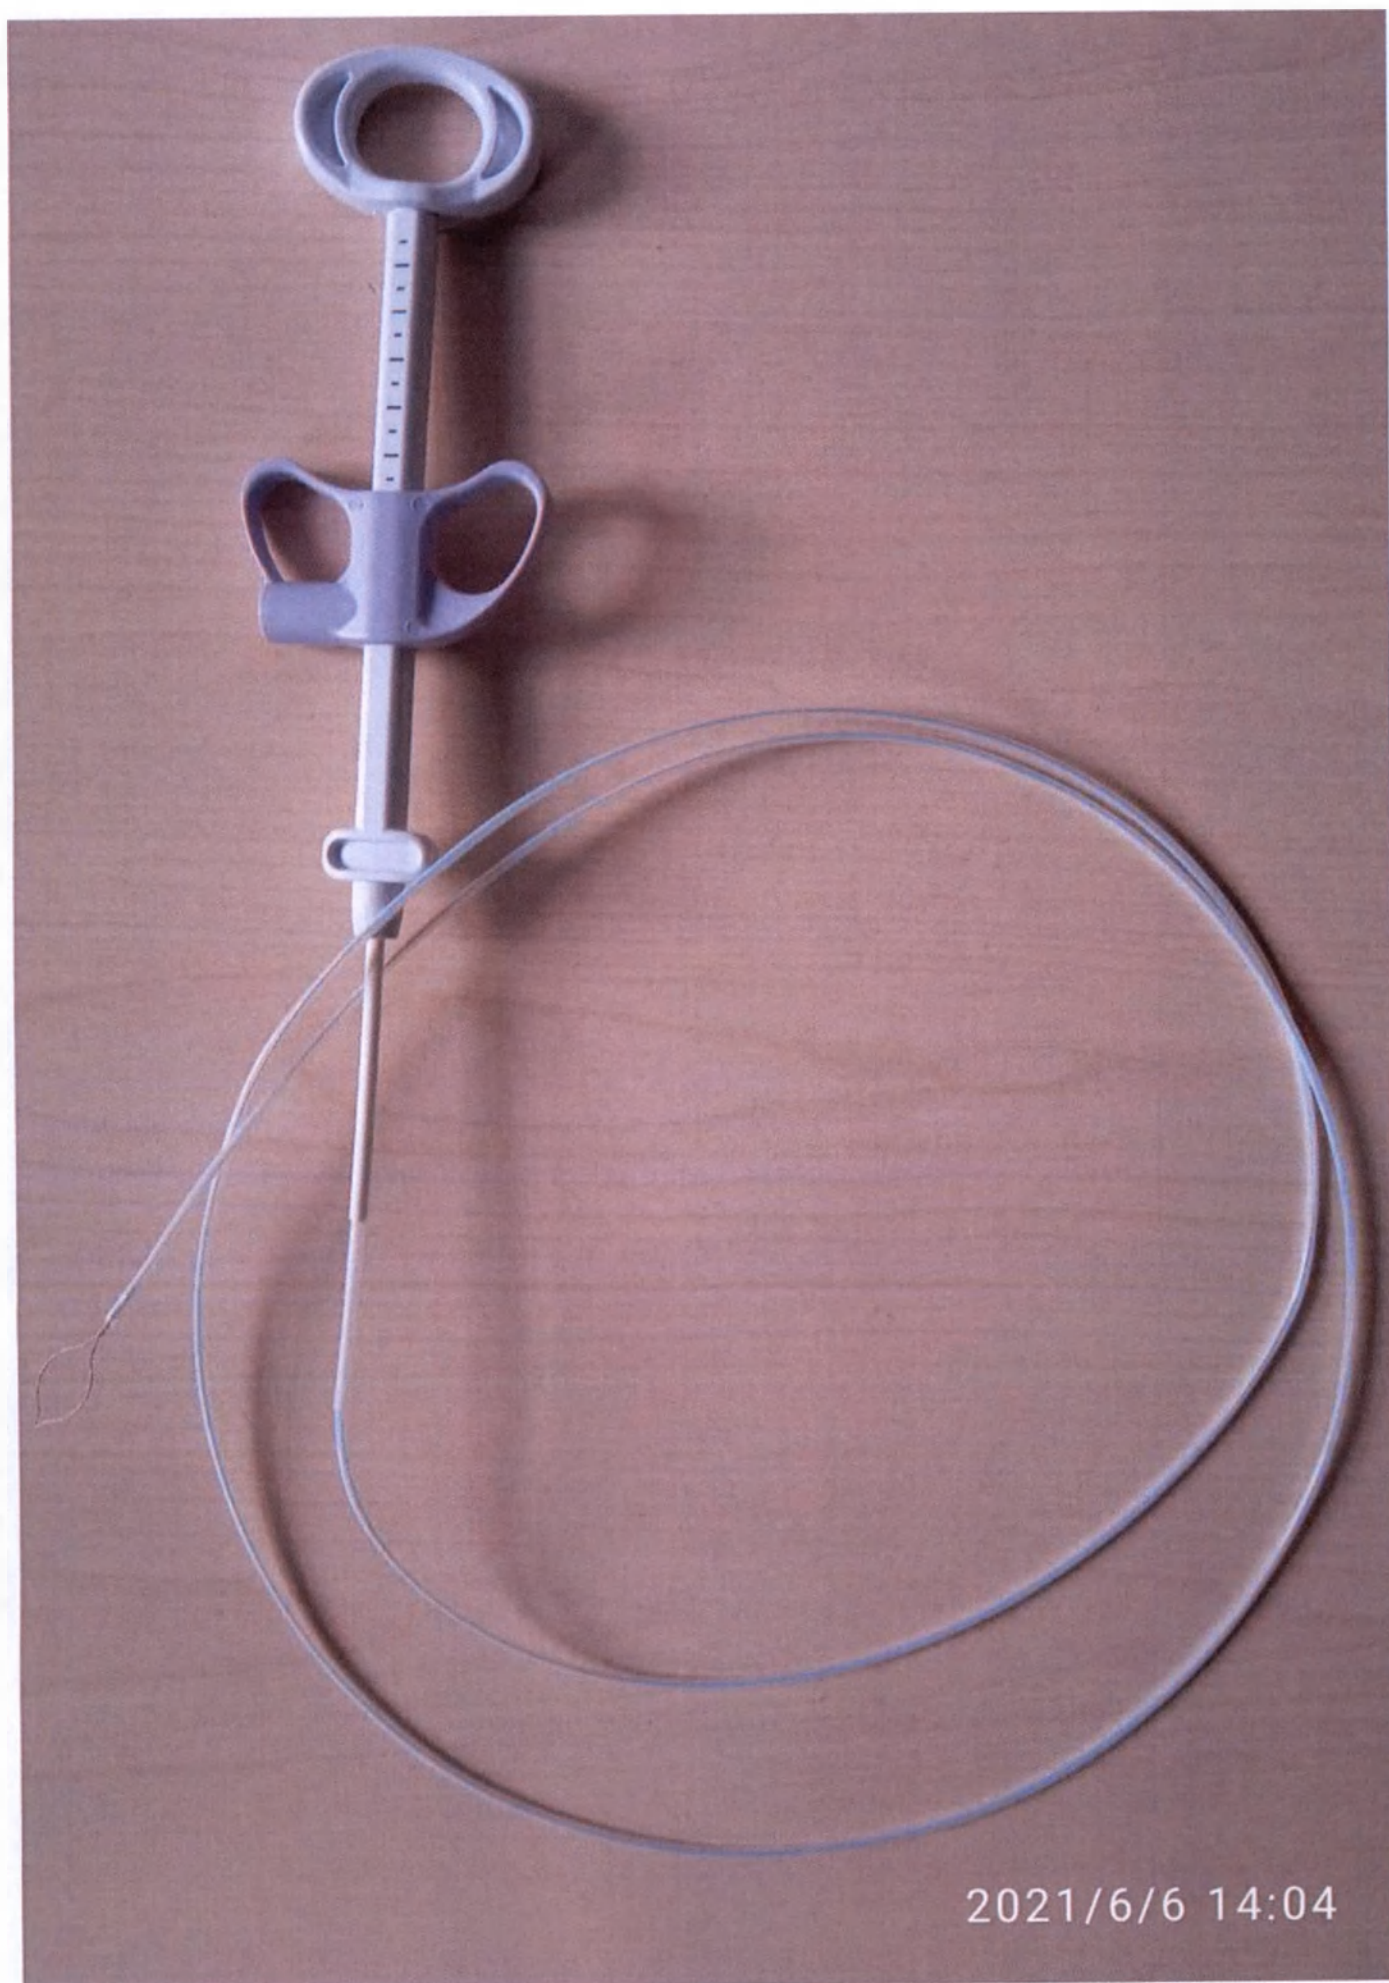


2021/6/6 14:04


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-30 (в первичной упаковке)

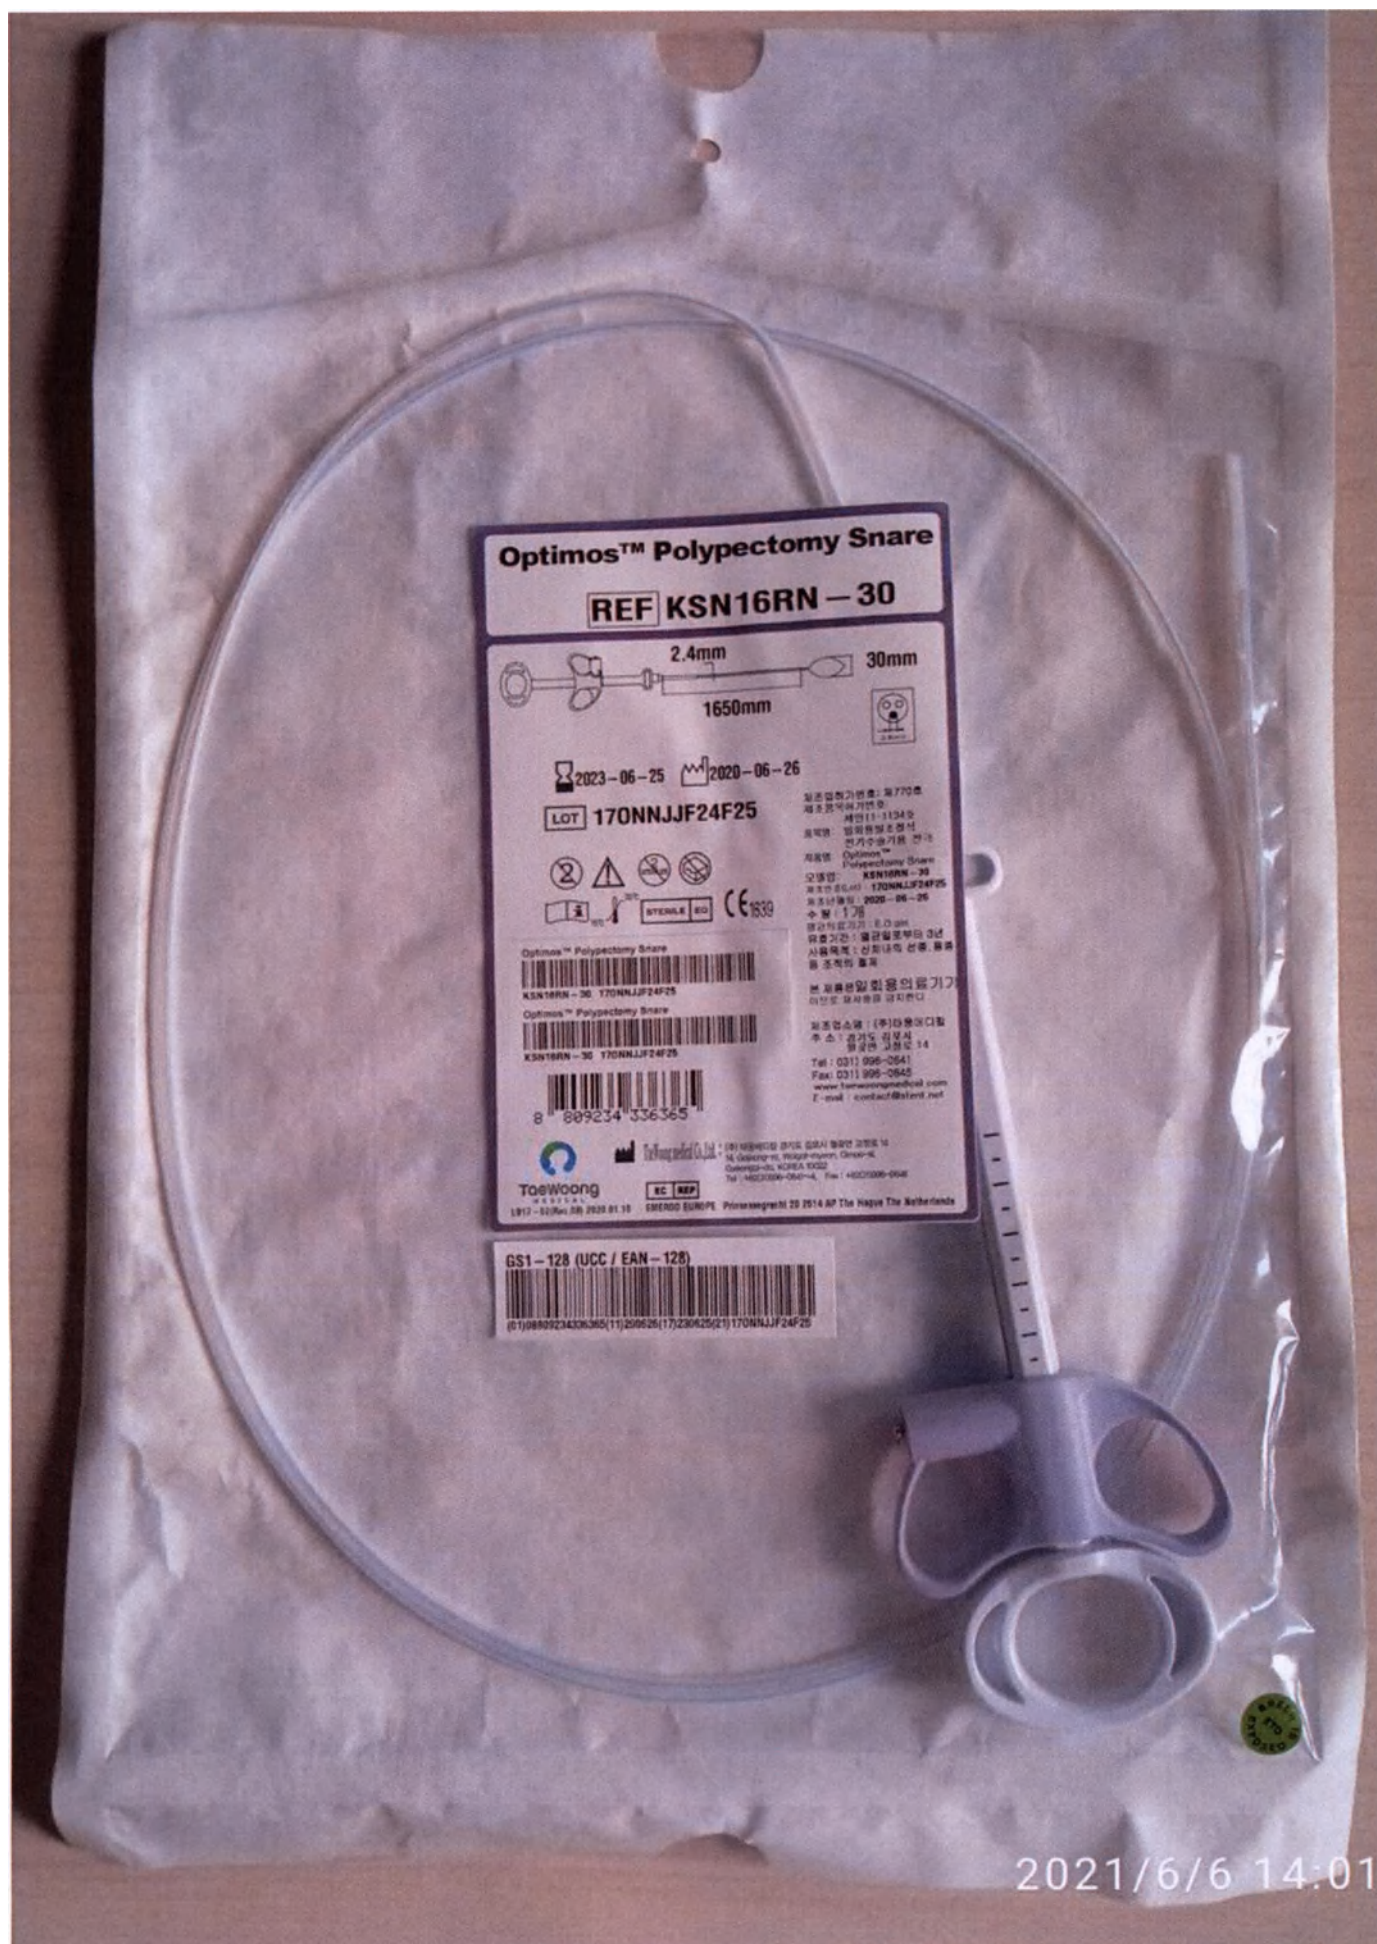

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16RN-30(во вторичной упаковке)

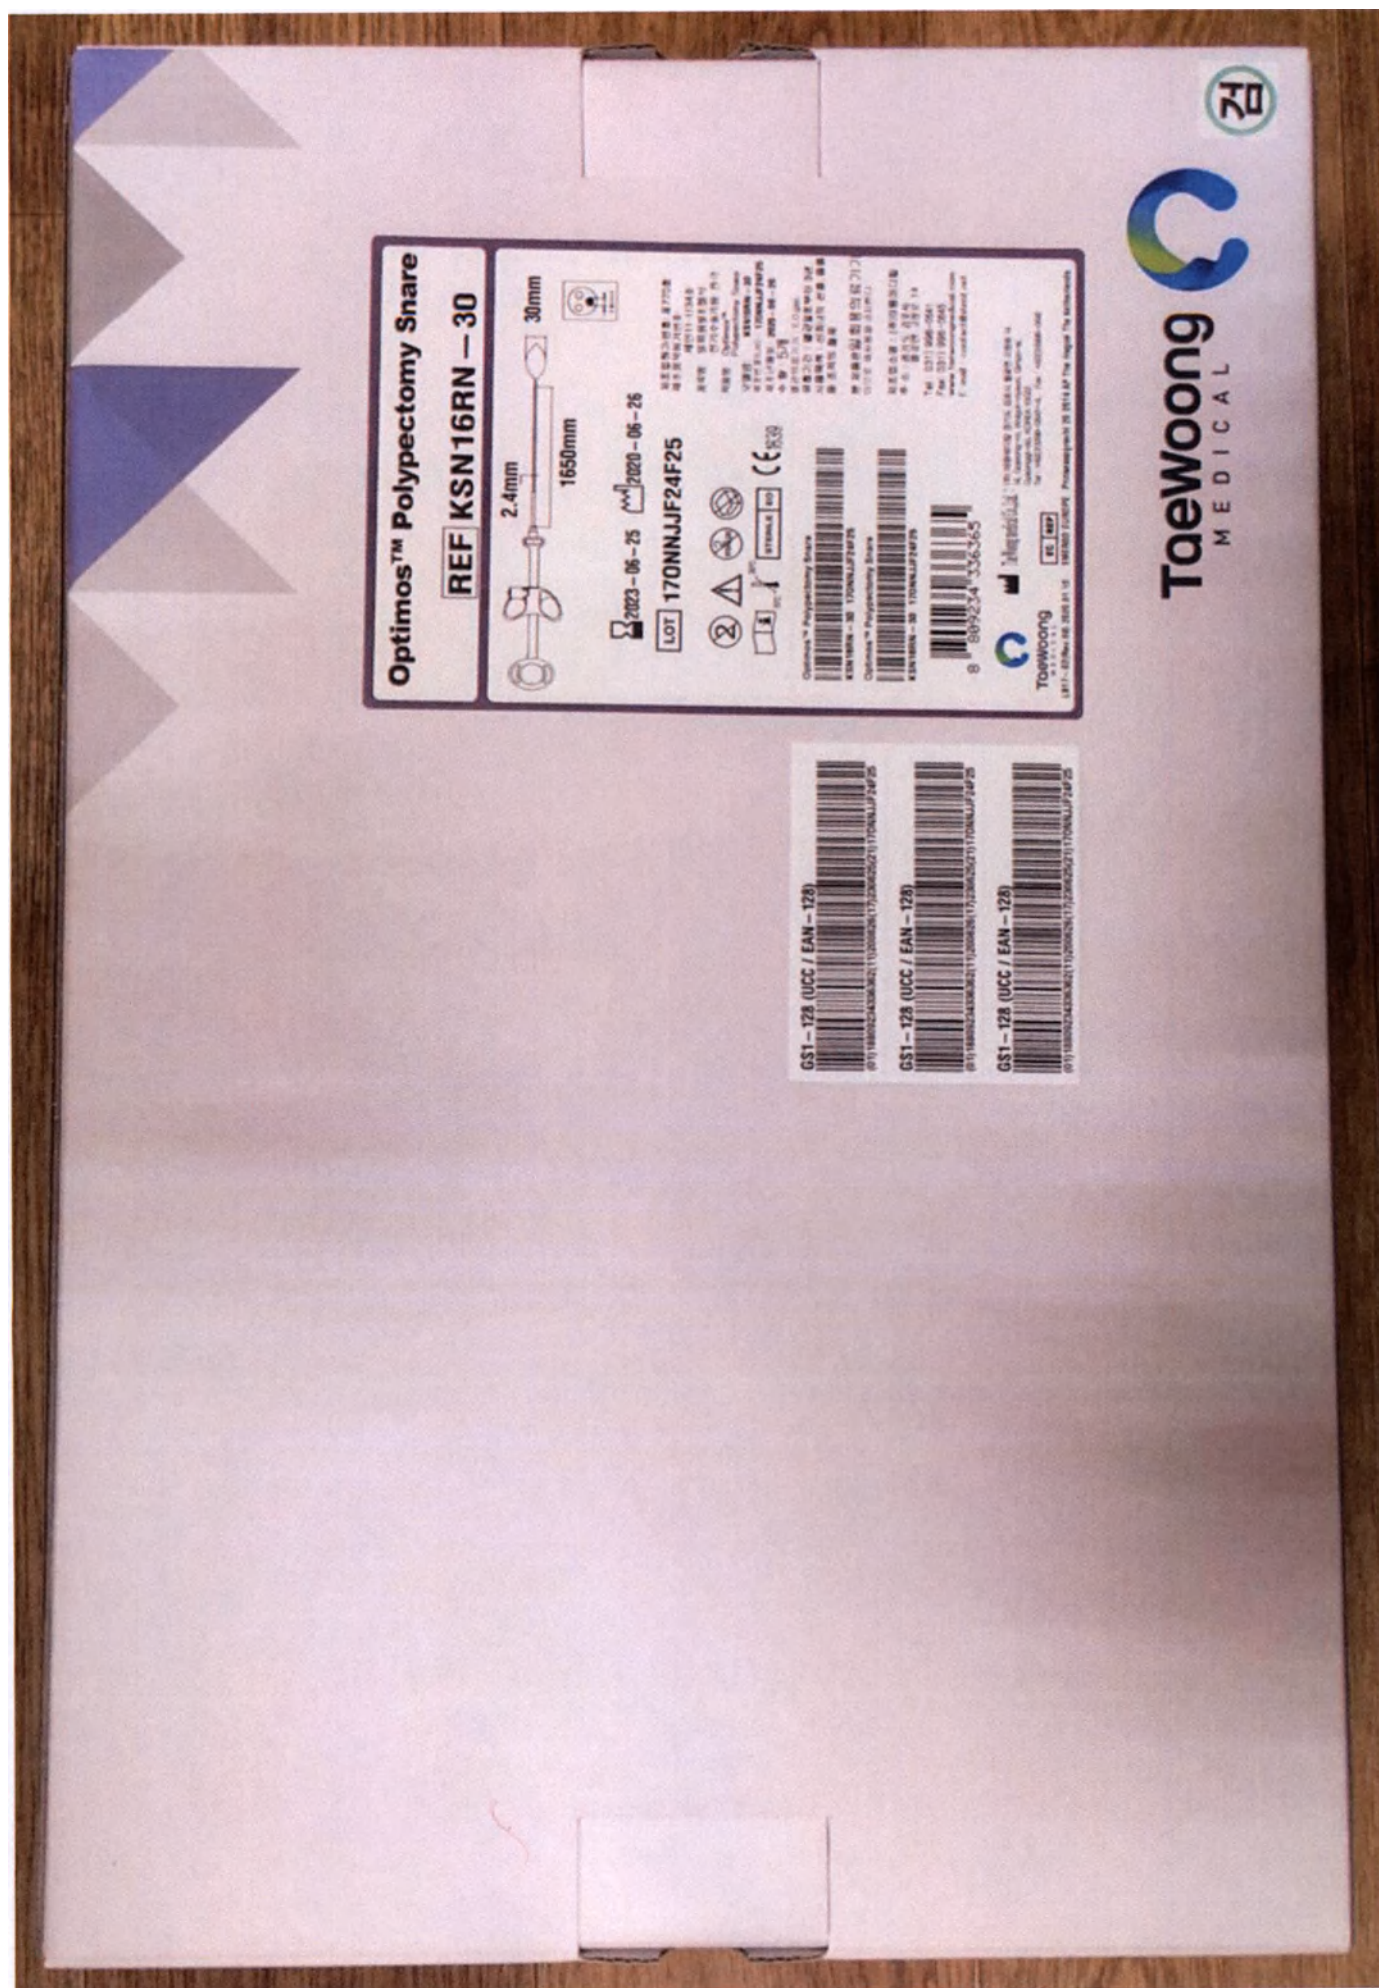

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-30

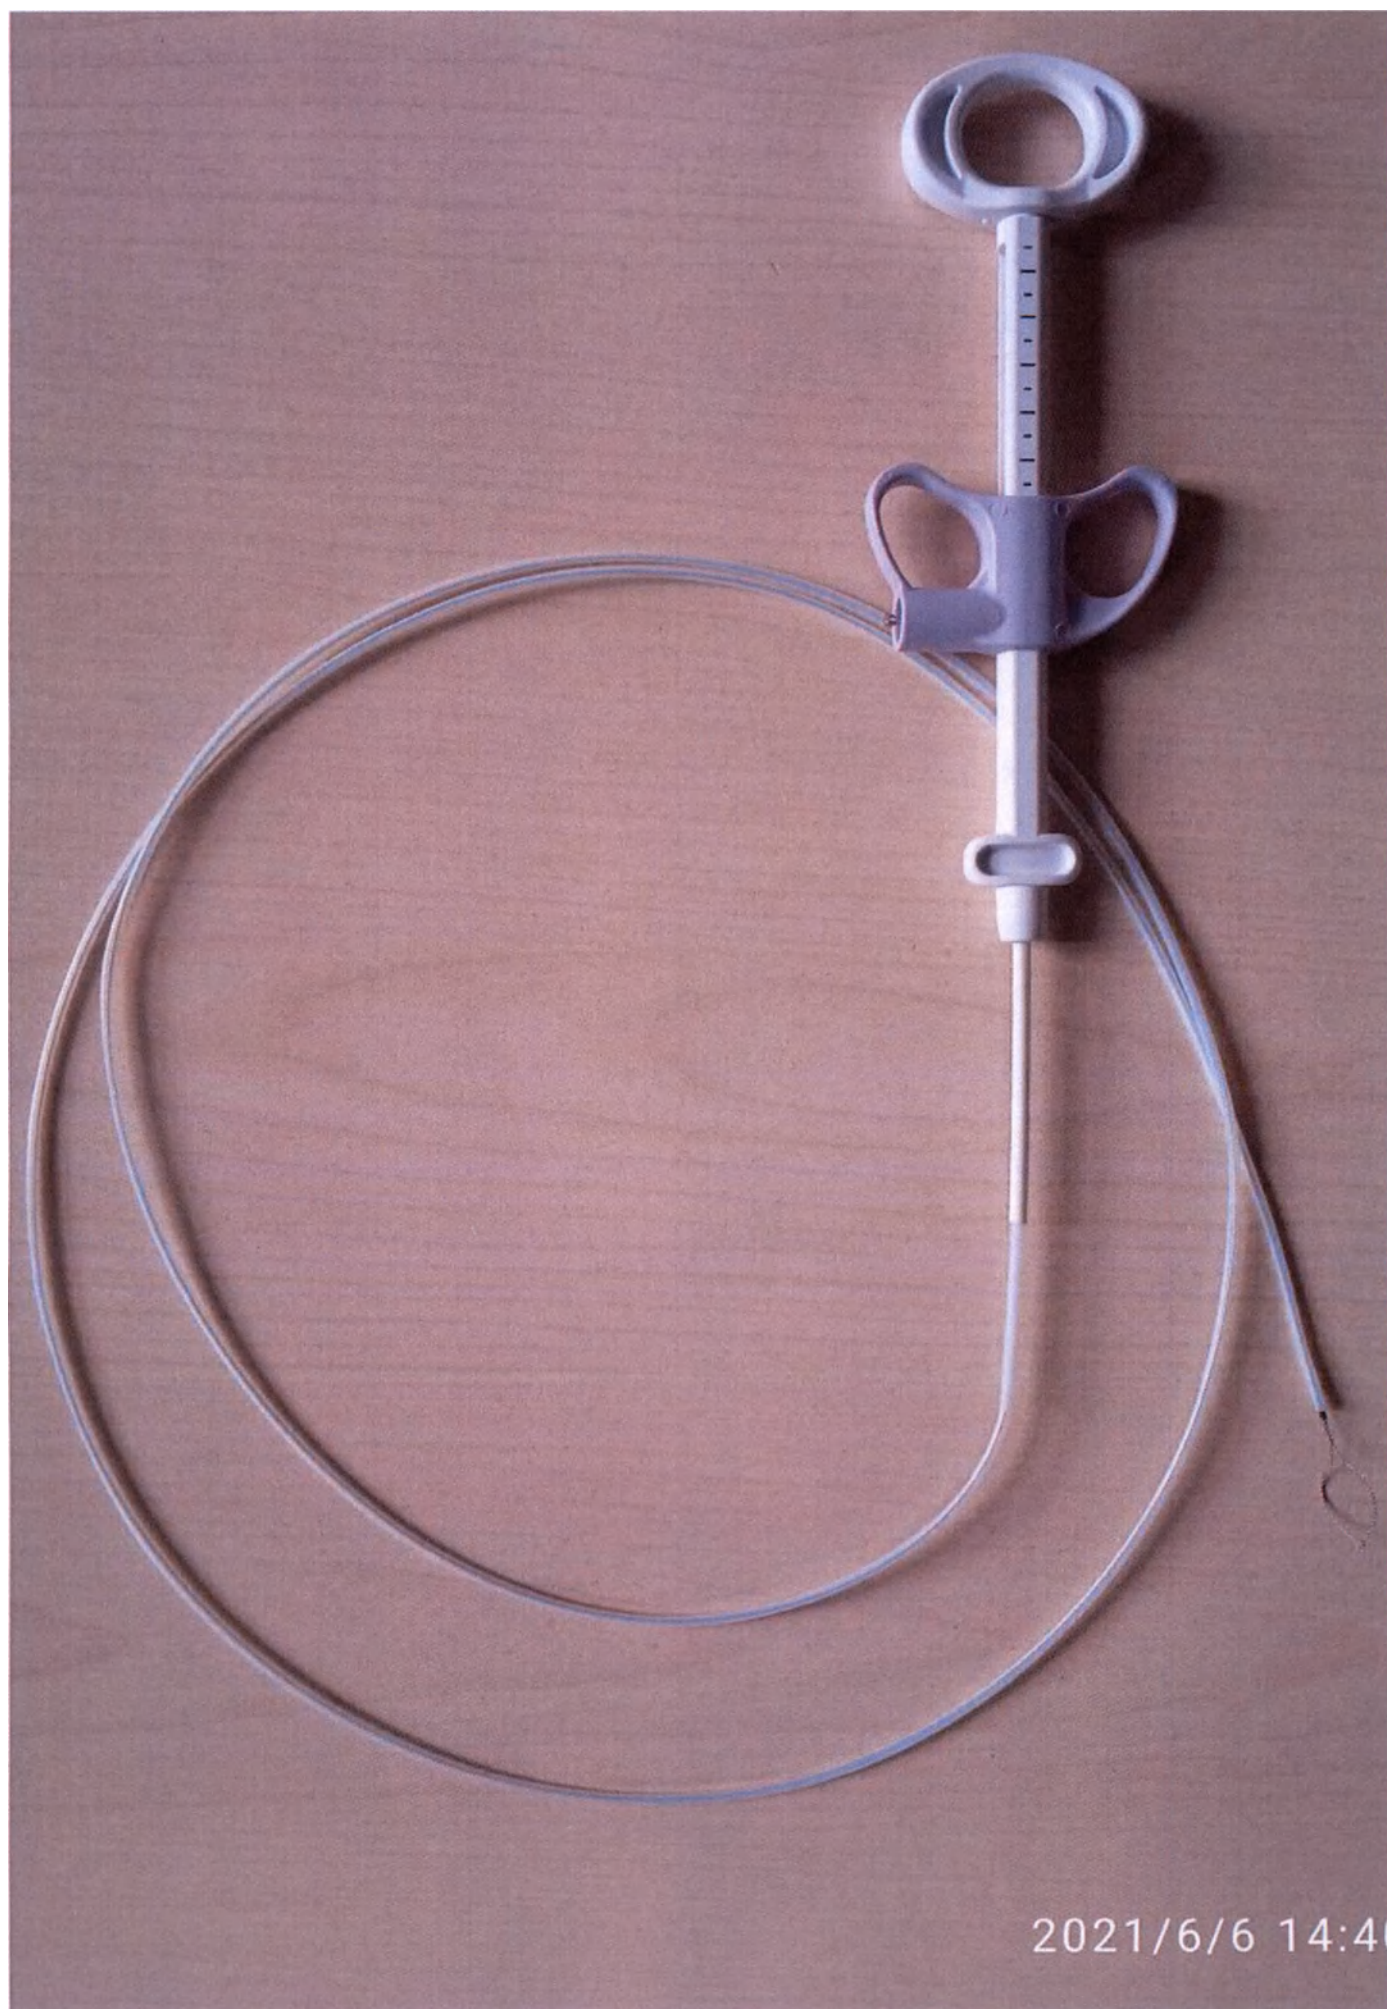


2021/6/6 14:40

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-30 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RN-30(во вторичной упаковке)

Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN23RN - 30



2.4mm 30mm

2023-06-25 2020-06-26
LOT 170NNEJF24F25

ISO 13485
CE
RoHS
REACH
VCE


Optimos™ Polypectomy Snare
KSN23RN - 30 170NNEJF24F25
Optimos™ Polypectomy Snare
KSN23RN - 30 170NNEJF24F25
8 809253 838488

TaeWoong MEDICAL
1817 - Yuseong-ro 303 31 10 DONGNAE-GU DAEJEON KOREA
Phone: +82-42-850-1114 Fax: +82-42-850-1115
E-mail: taewoong@taewoong.co.kr




GS1-128 (UCC / EAN - 128)
GS1-128 (UCC / EAN - 128)
GS1-128 (UCC / EAN - 128)

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RNS-10

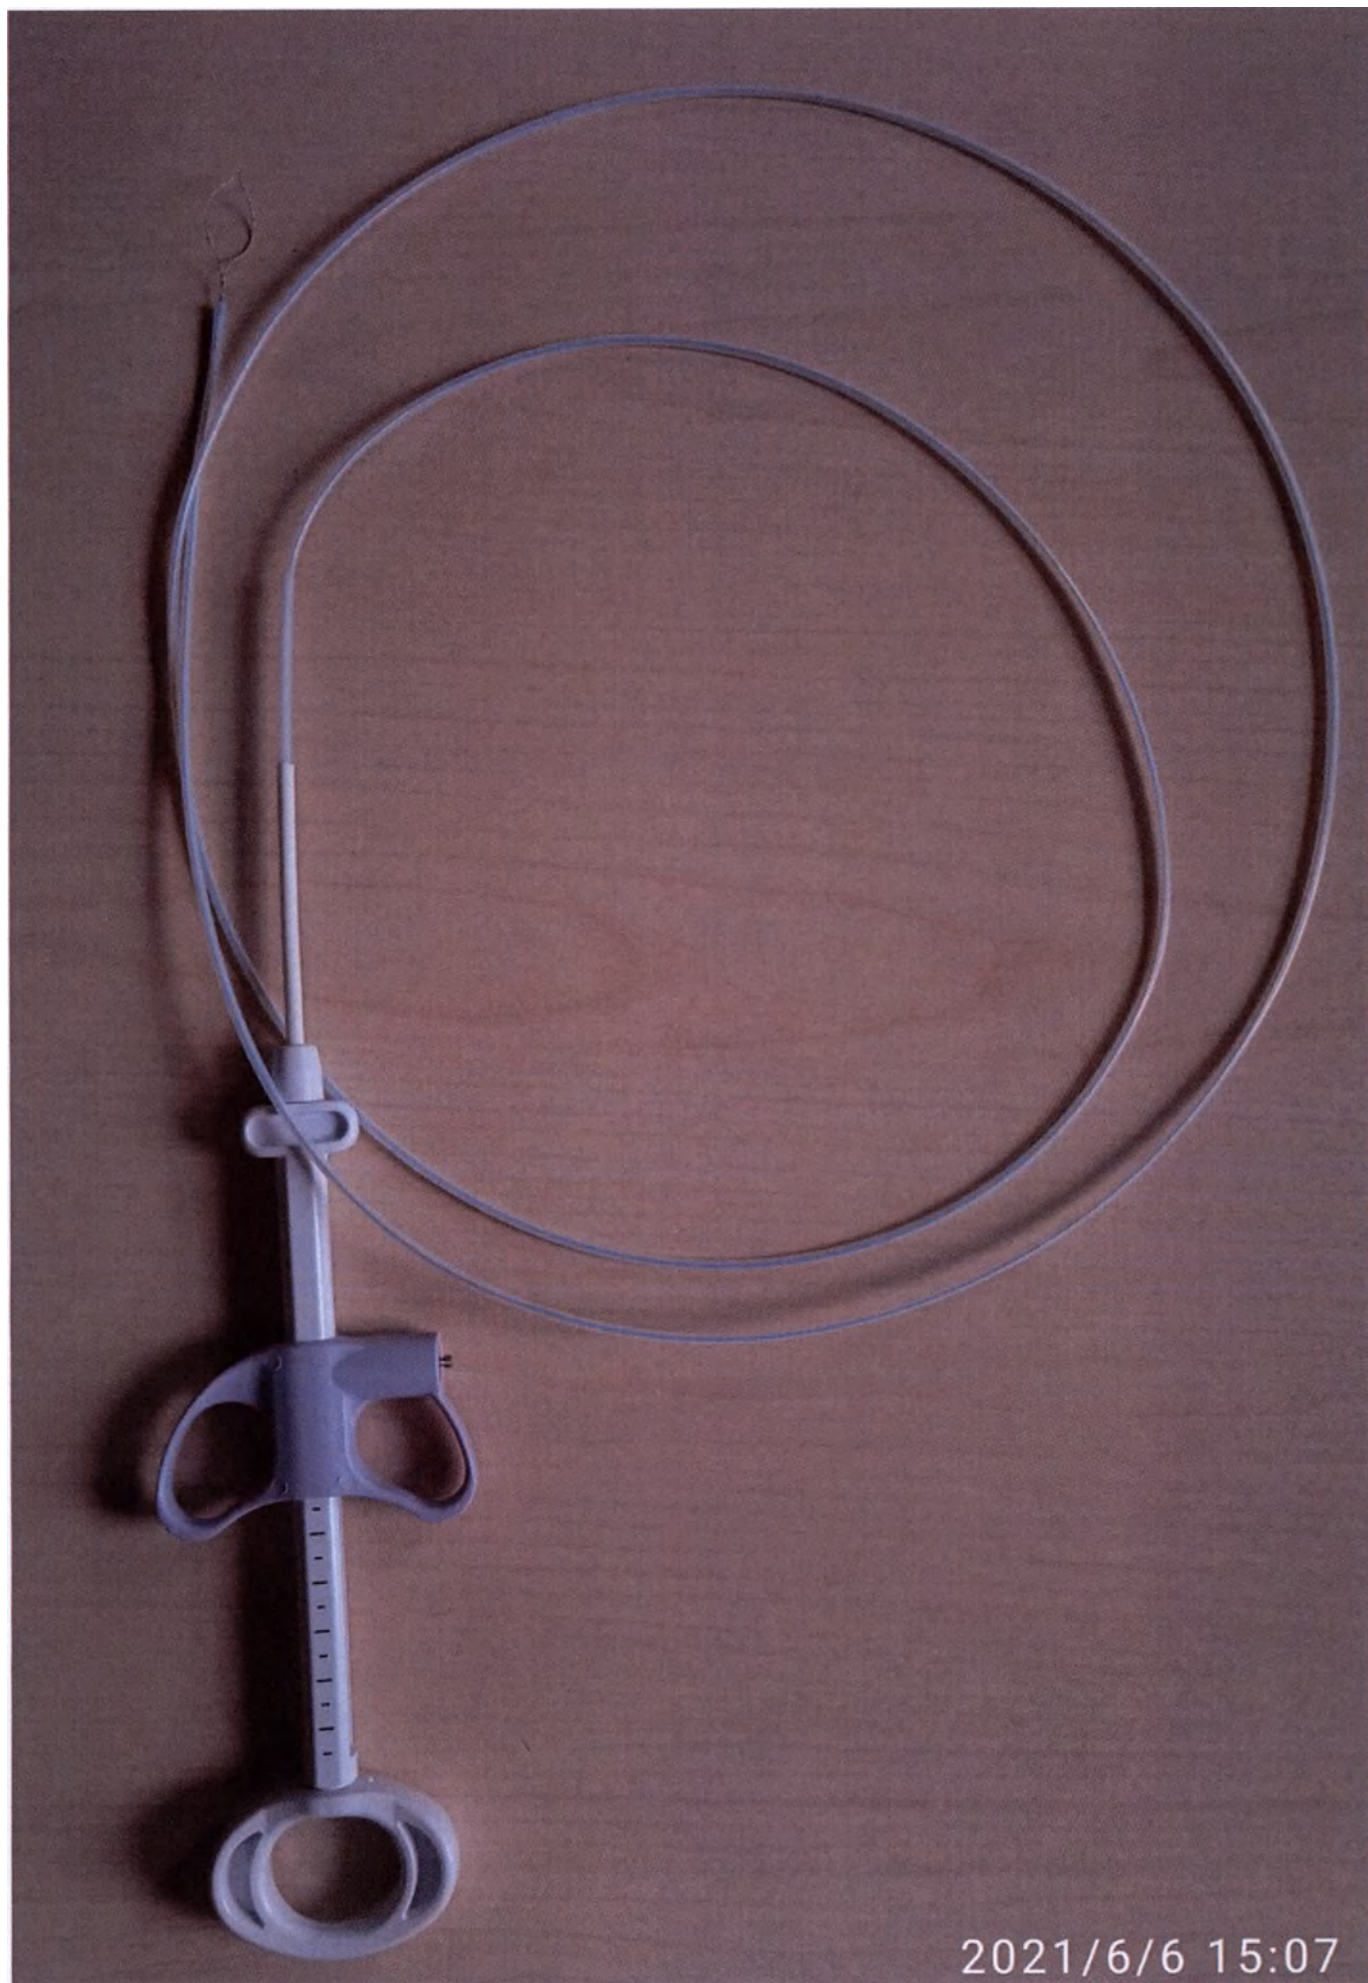

2021/6/6 15:07

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RNS-10 (в первичной упаковке)

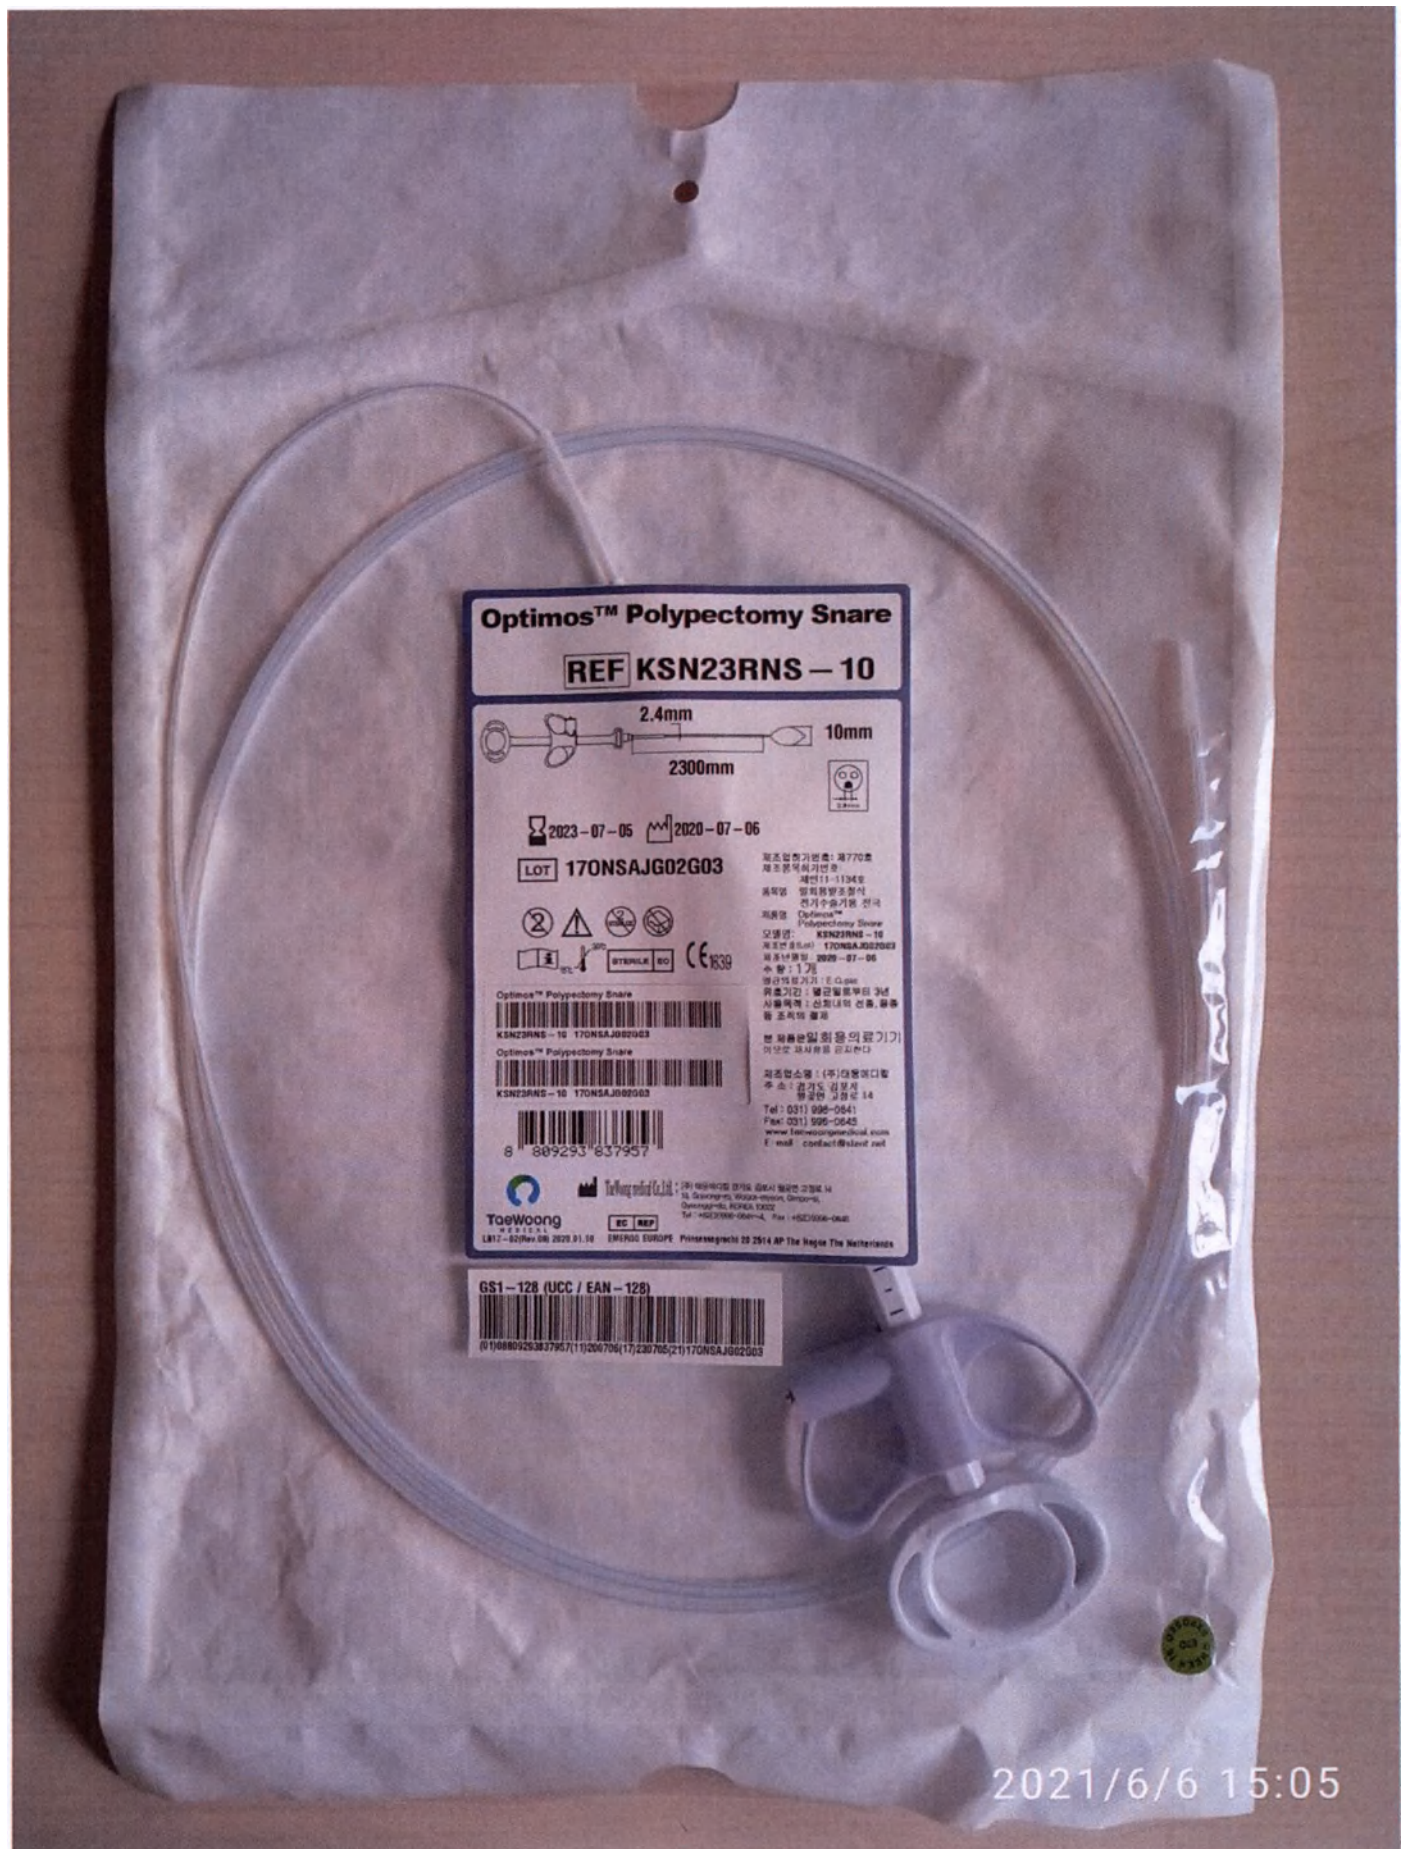

2021/6/6 15:05

[illegible]

GS1-128 (UCC / EAN - 128)

(01) 168606293679564111200706 (17) 250706 (21) 170686A J02503

GS1-128 (UCC / EAN - 128)


(01) 168606293679564111200706 (17) 250706 (21) 170686A J02503

GS1-128 (UCC / EAN - 128)

(01) 168606293679564111200706 (17) 250706 (21) 170686A J02503

Taewoong
MEDICAL

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RNS-15

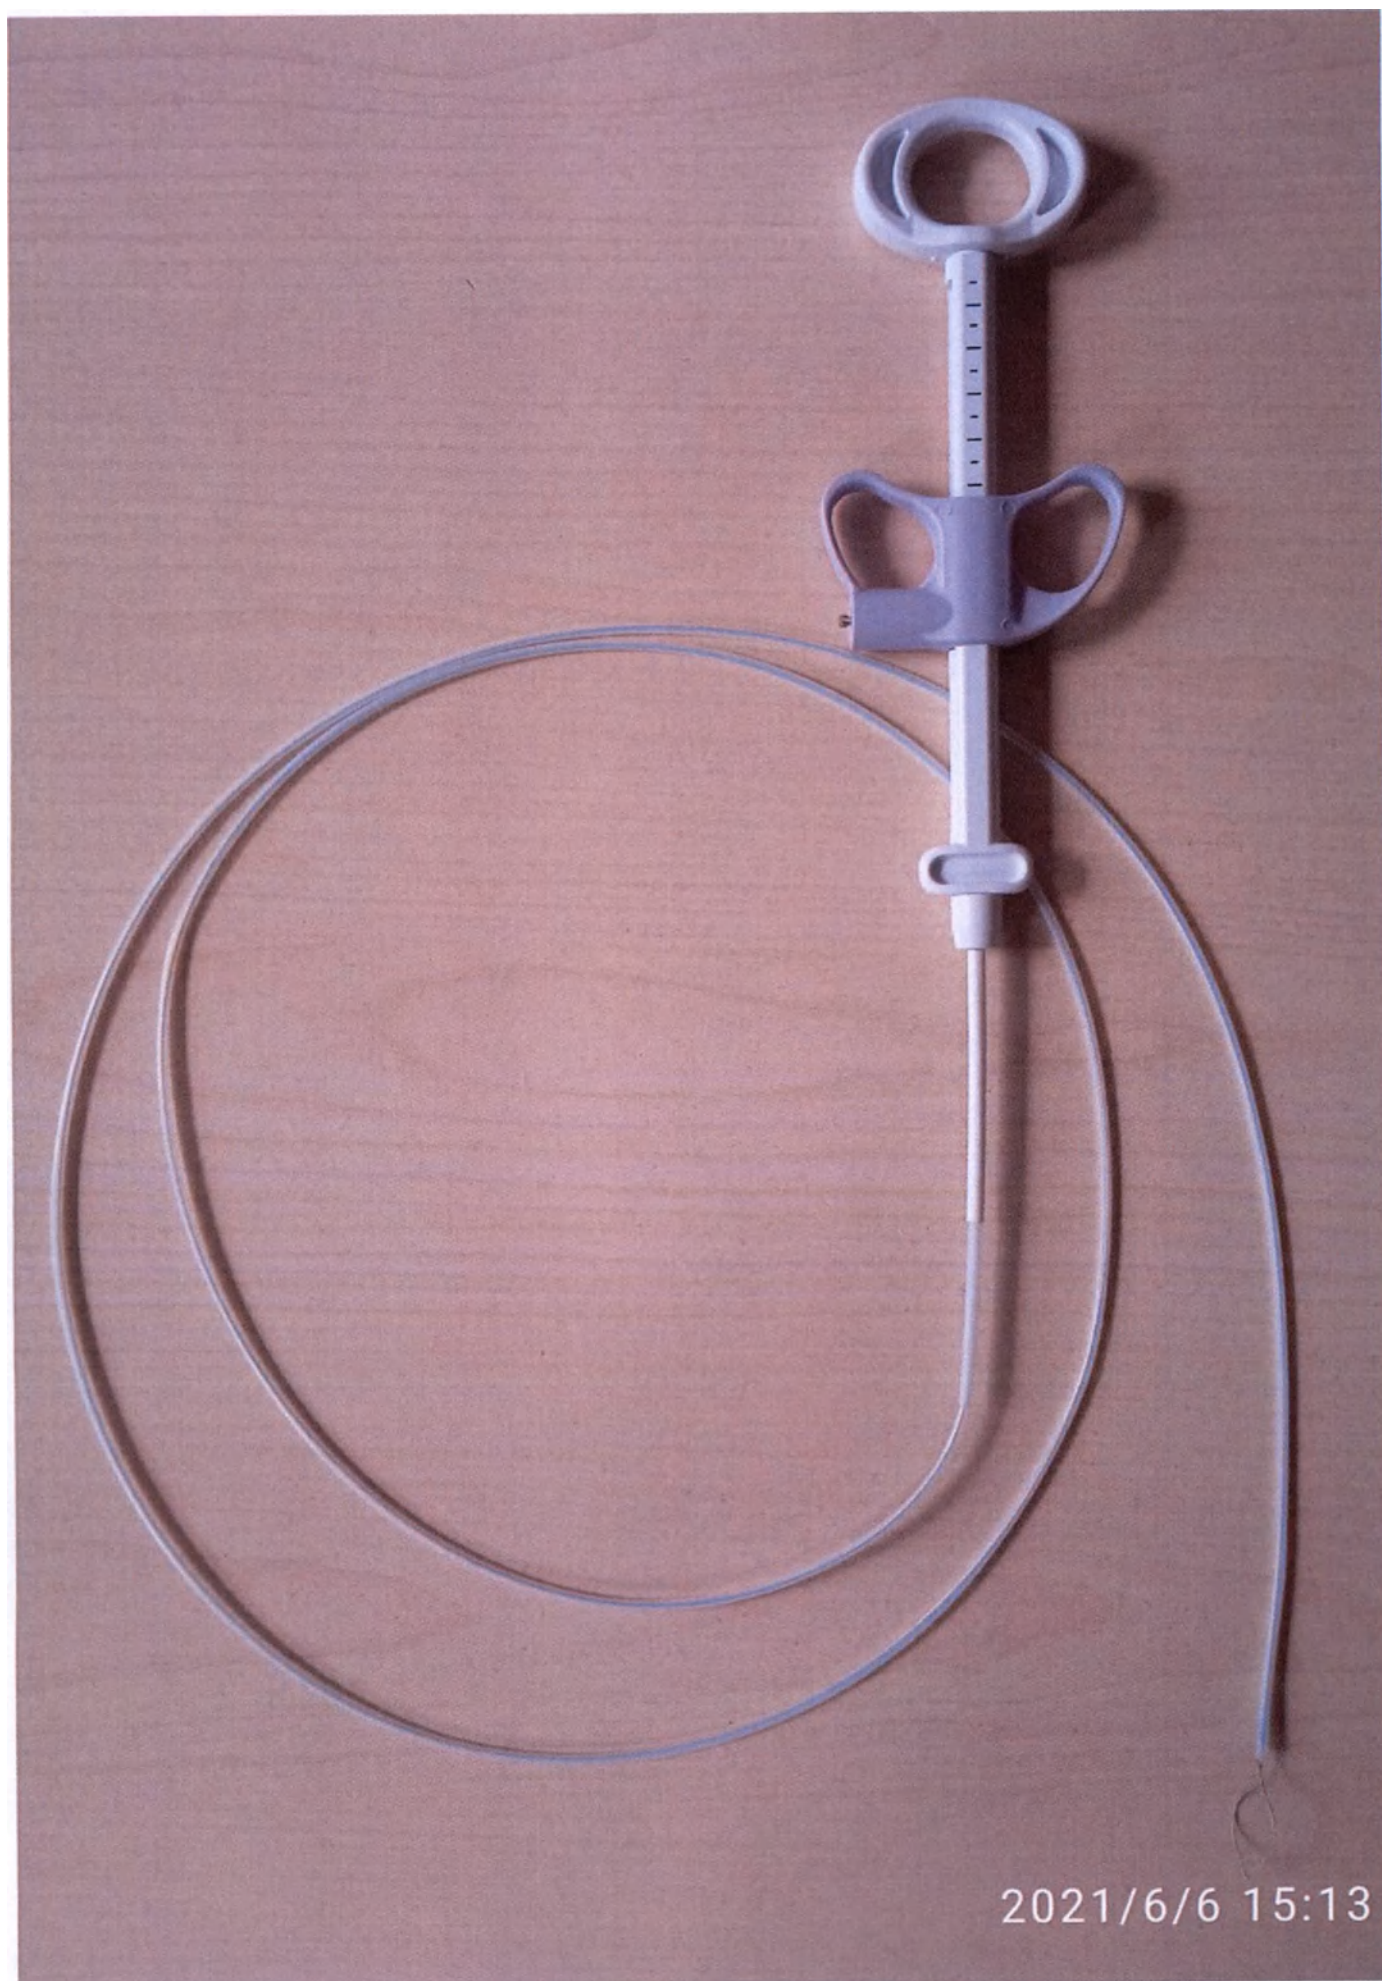


2021/6/6 15:13

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RNS-15 (в первичной упаковке)



Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN23RNS - 15



2023-07-05 2020-07-06

LOT 170NSBJG02G03

④

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

™ Polycapillary Bundle

NS - 15 170689-900000

...the Polypetromy Sinate

0985-16 1704364037563

100



809293 837971

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Buongiorno

tel. 06/5737896 - fax 06/5737897
Quercia 127-051 - 41532-A 100322
M. Lombardi - 06/5737898

[illegible]

1

Toewo

MEDI

10

100


GS1-128 (UCC / EAN-128)




GS1-128 (UCC / EAN-128)



331-128 (UCC / EAN-128)

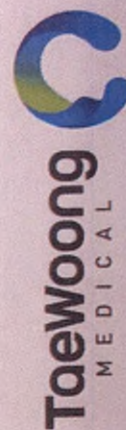

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23RNS-20

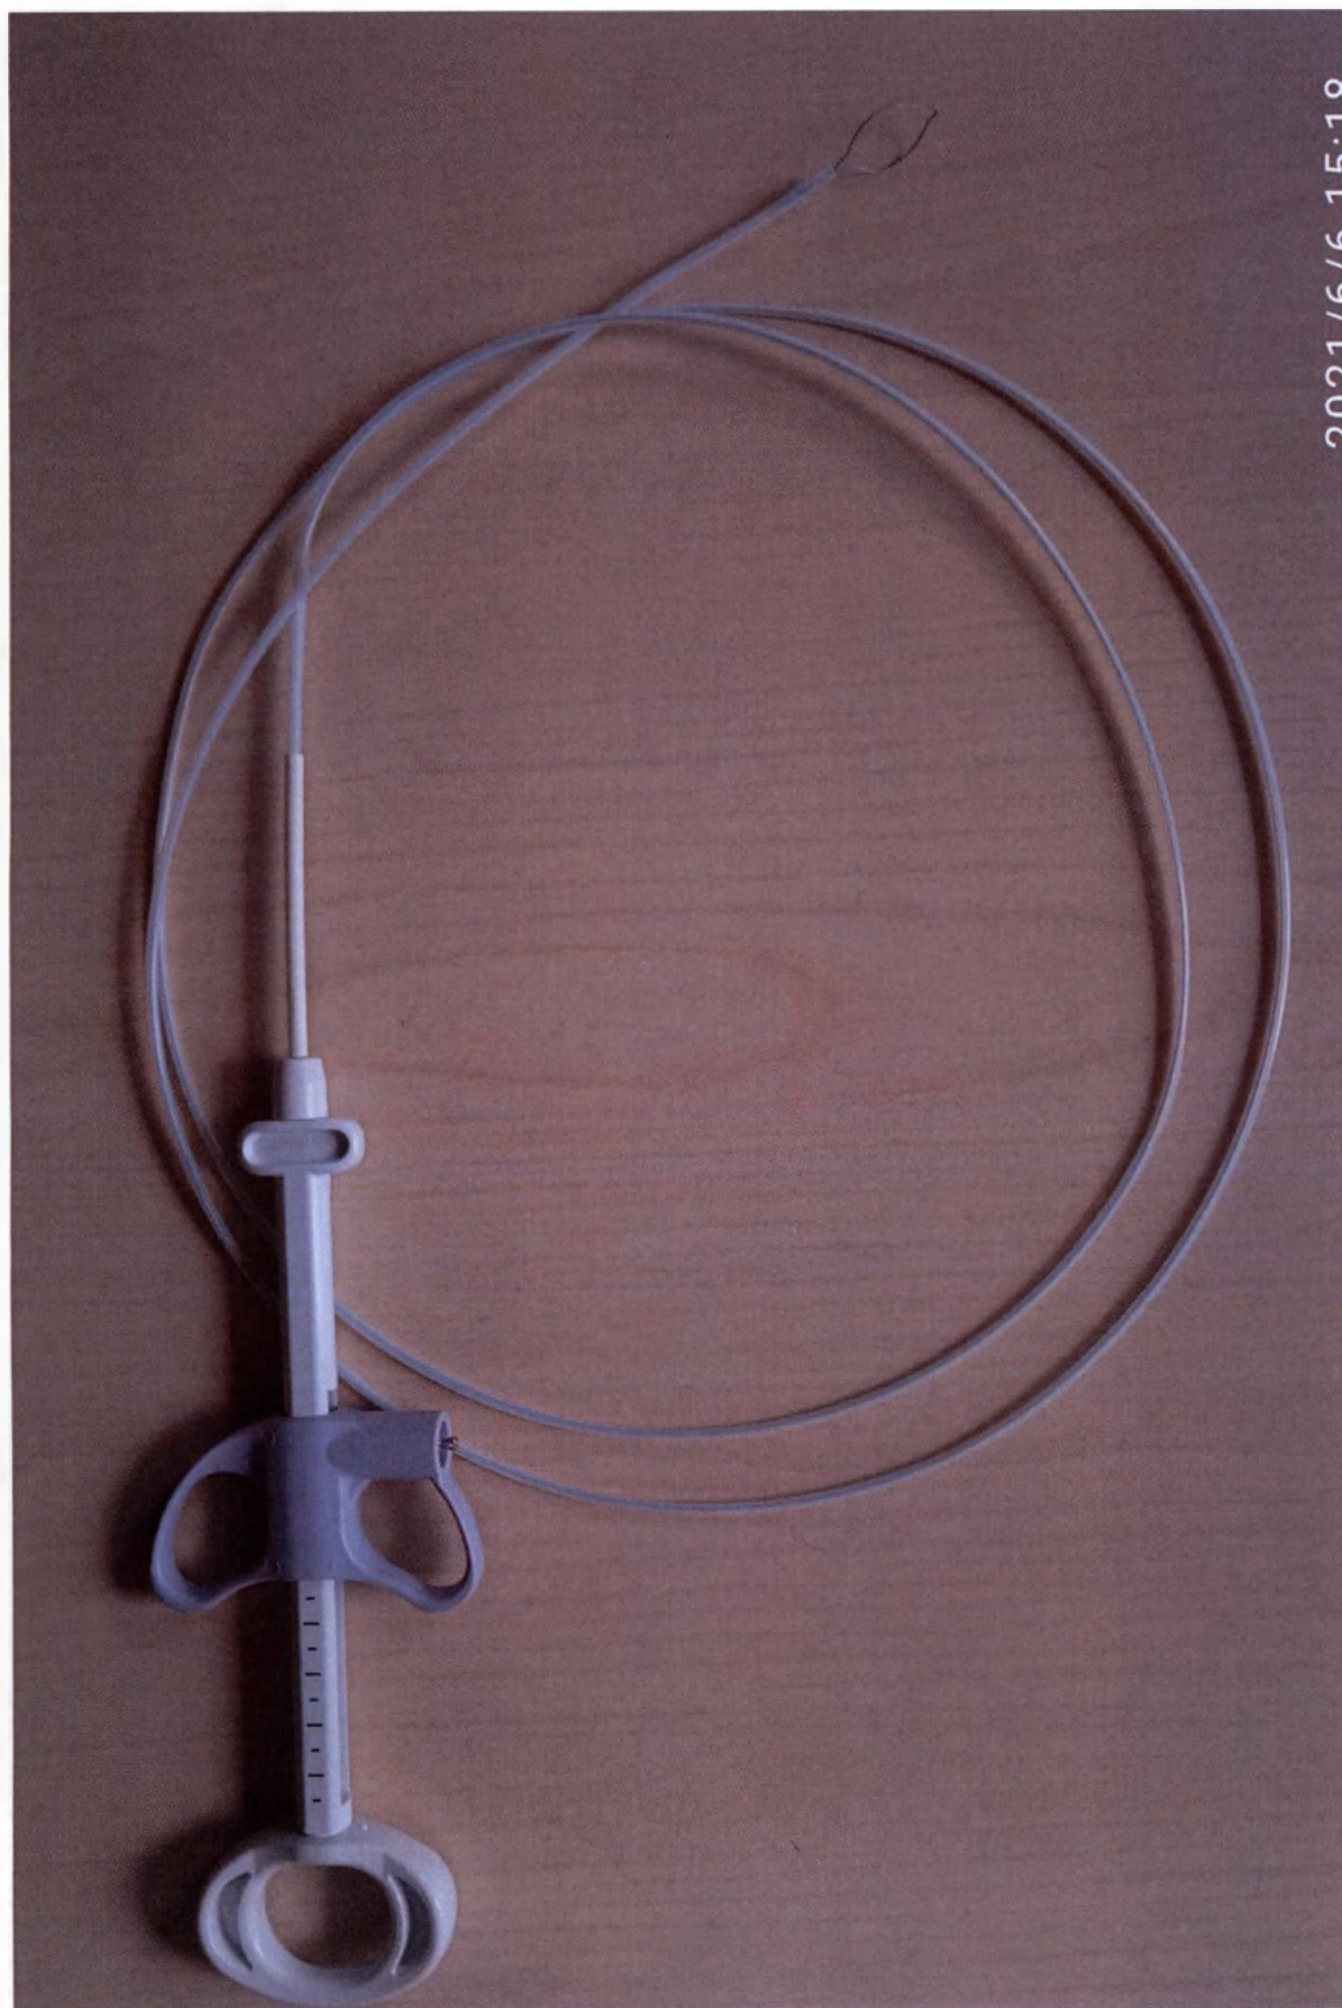

2021/6/6 15:19

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23RNS-10 (в первичной упаковке)

2021/6/6 15:17



Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN23RNS - 20

2.4mm
 20mm
 2300mm

2023-07-05 2020-07-06

LOT 170NSCJG02G03

STERILE EO

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23RNS - 20 170NSCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23RNS - 20 170NSCJG02G03


8 889293 837964


TaeWoong
 MEDICAL

TaeWoong Medical Co., Ltd.
 191 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
 Tel: +82(31)996-0541 Fax: +82(31)996-0545
 www.taeWoongmedical.com E-mail: contact@tmed.net

GS1-128 (UCC / EAN-128)

(01)08809293837964(11)200706(17)230705(21)170NSCJG02G03

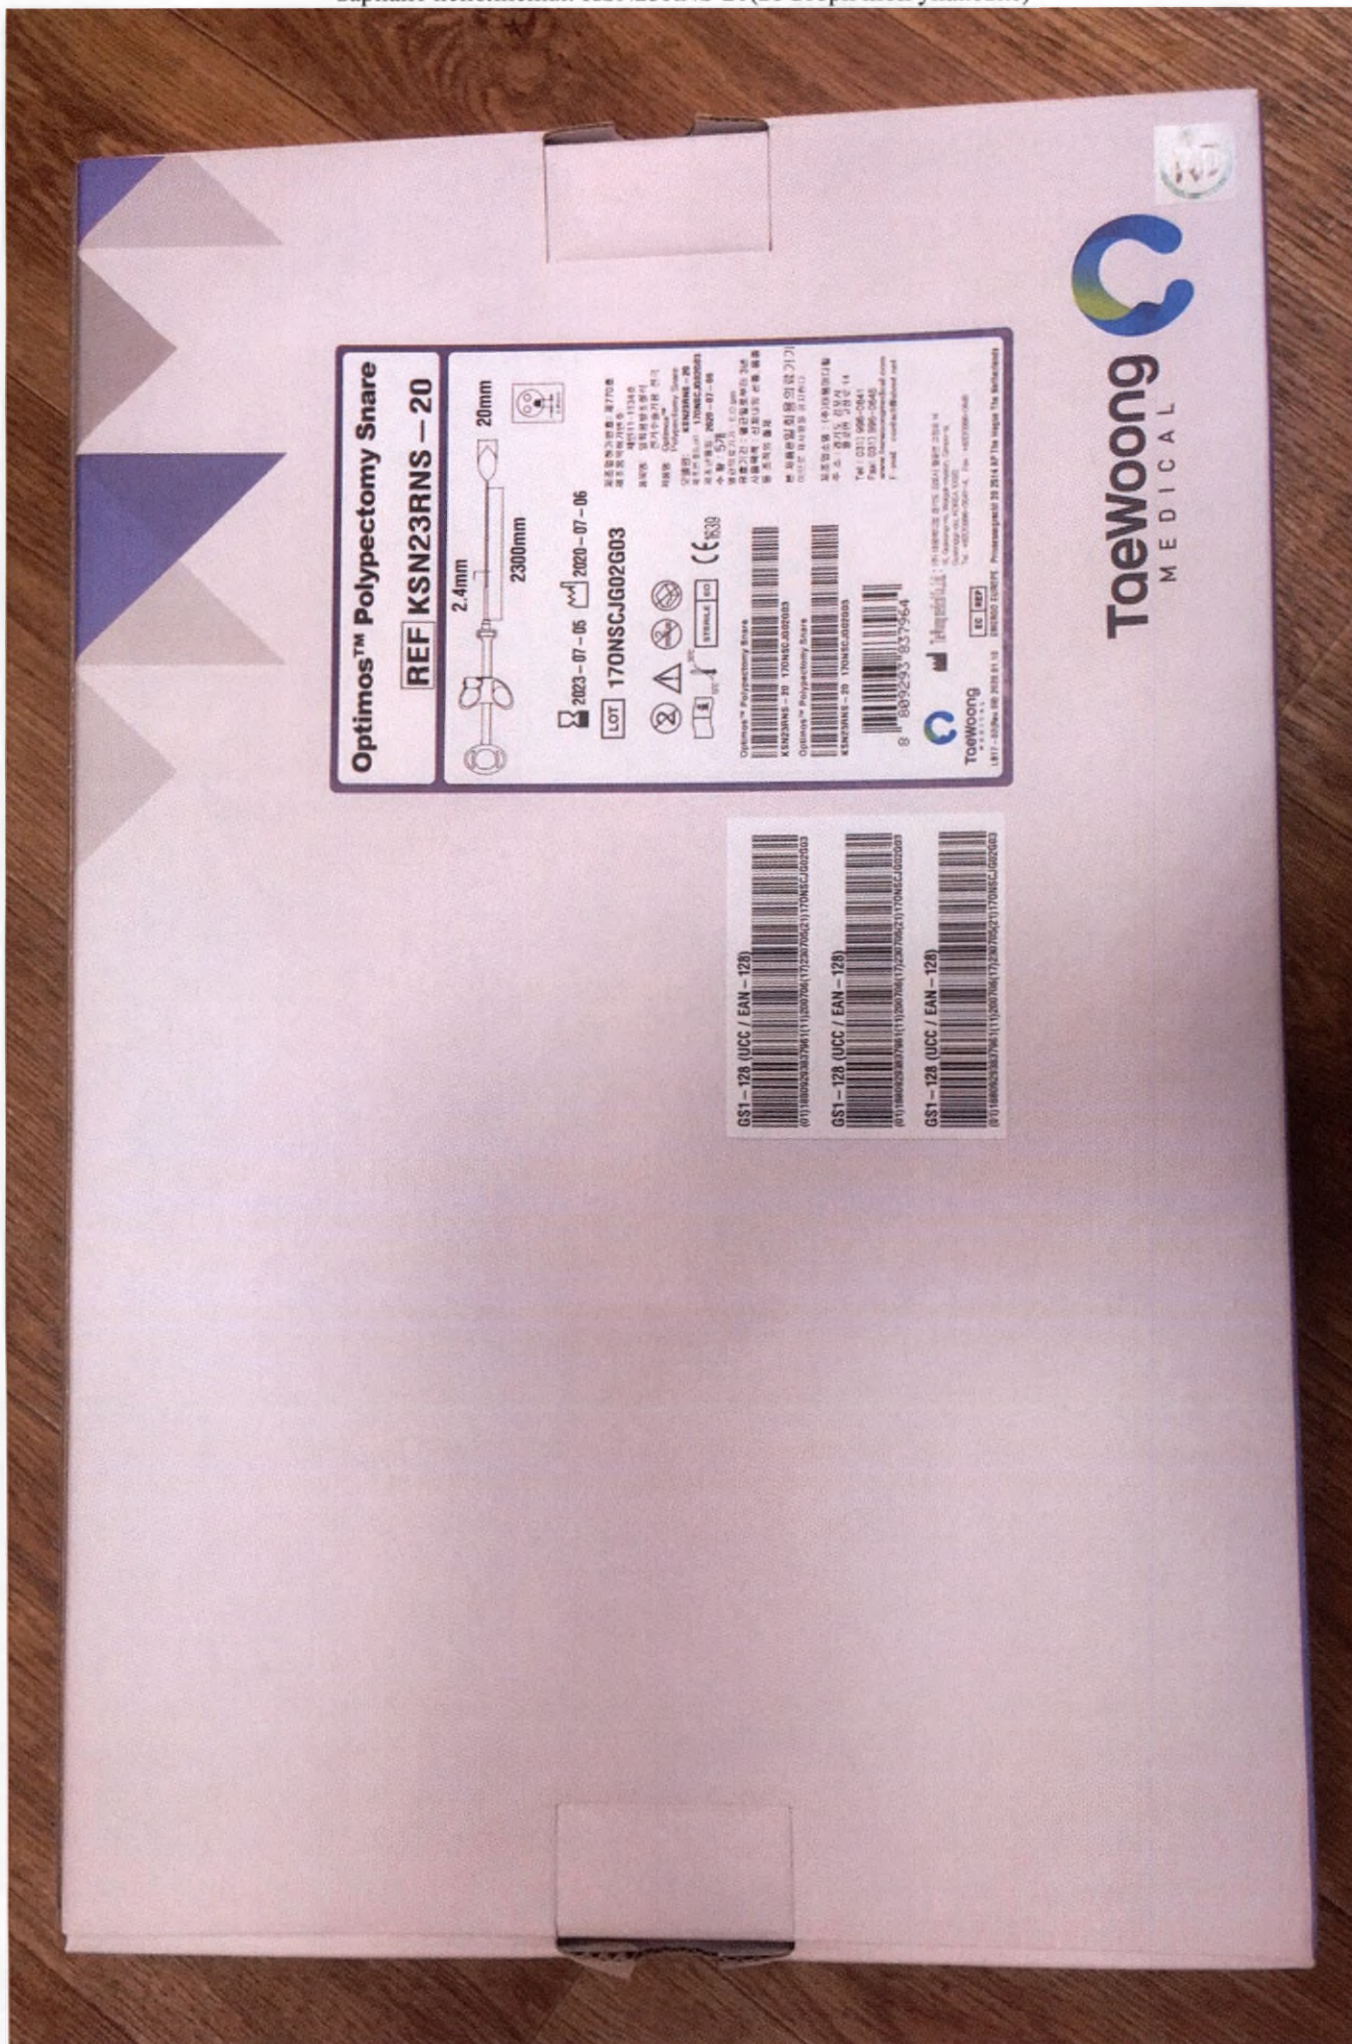

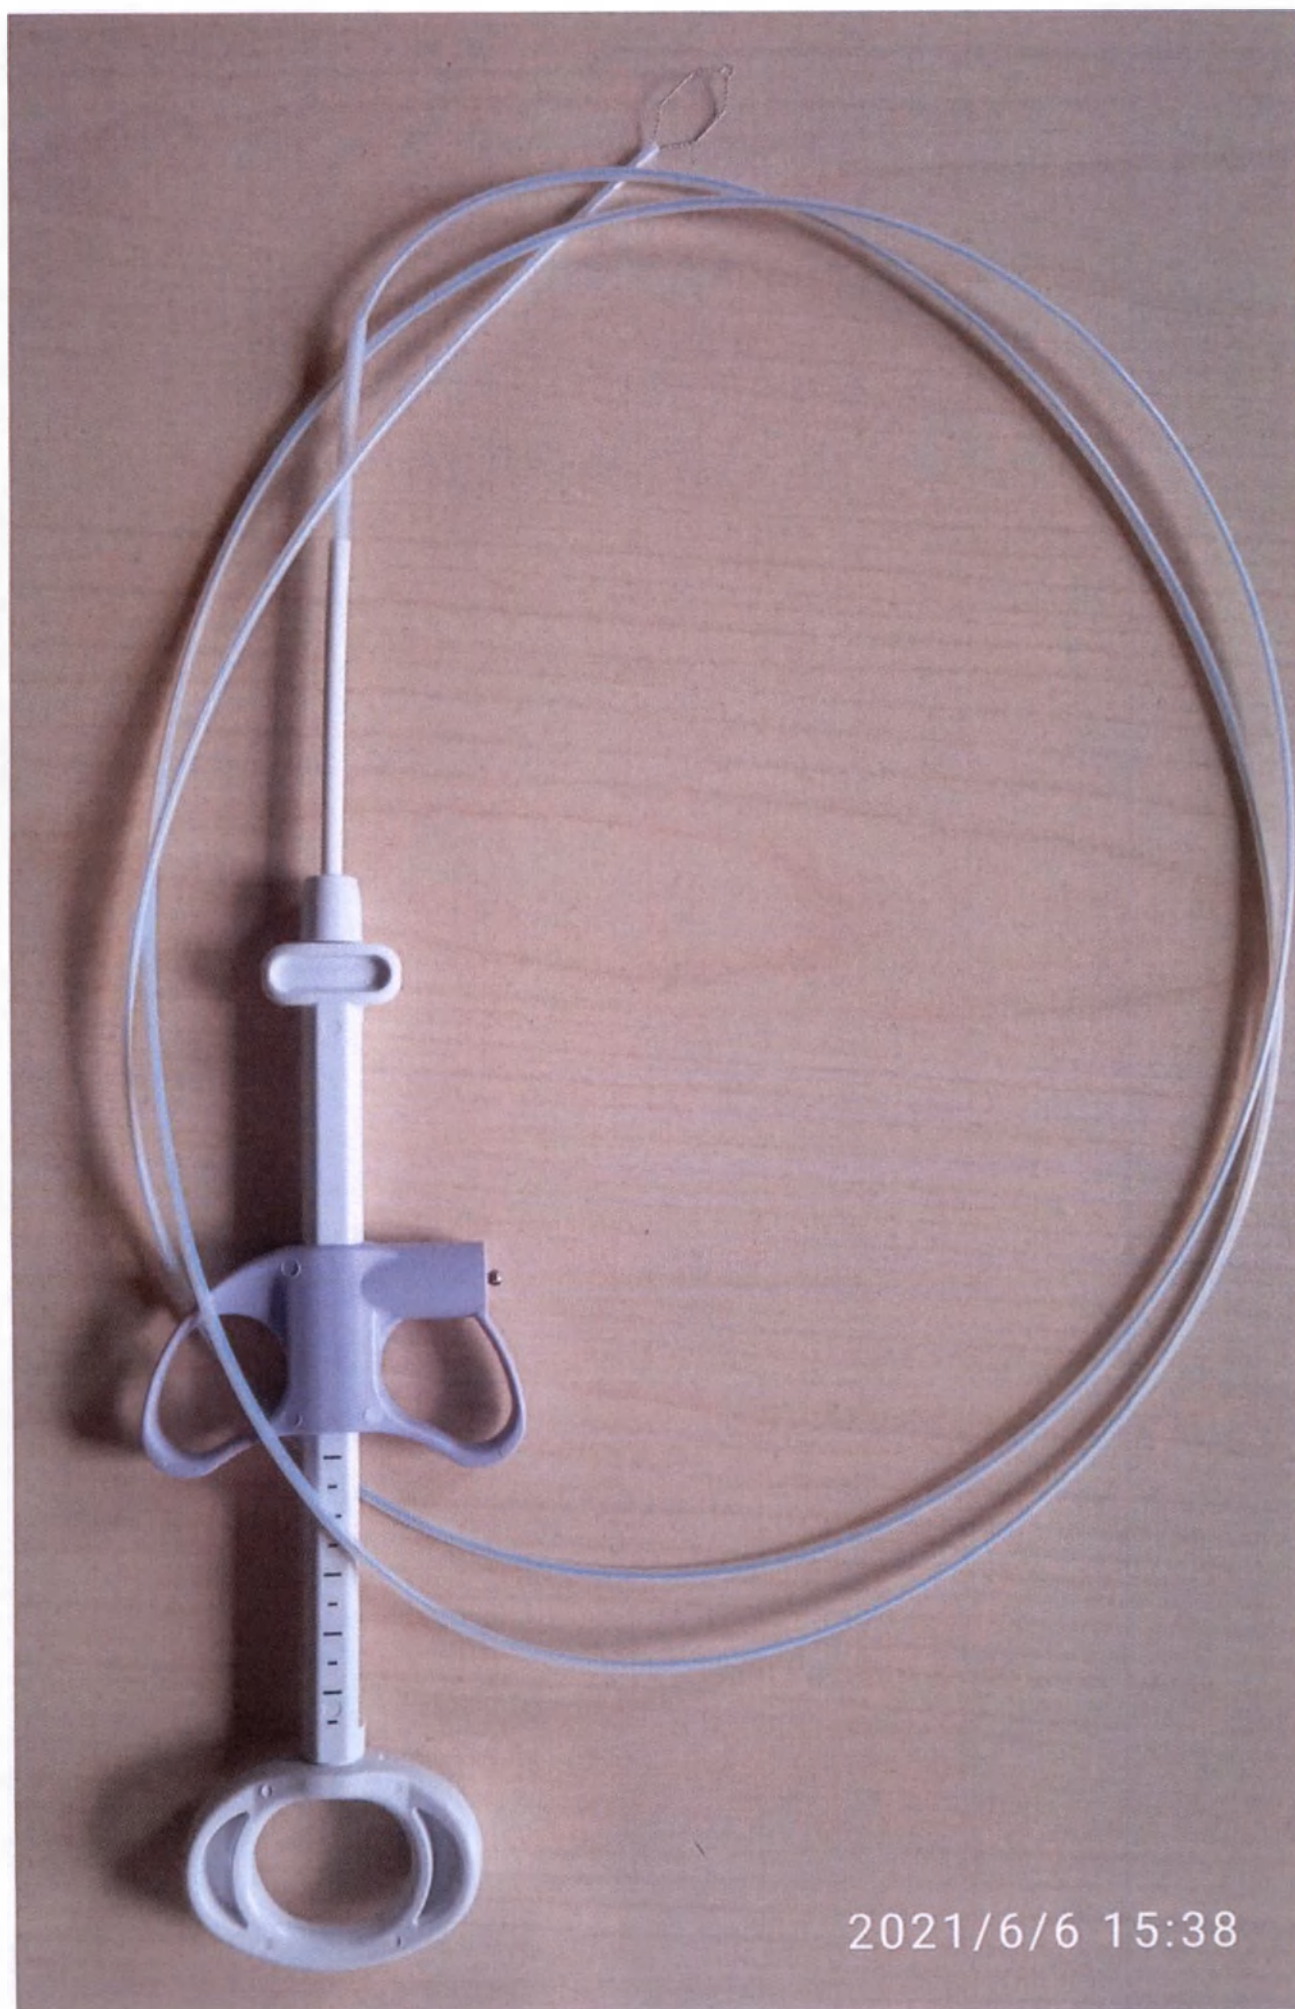


2021/6/6 15:38

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-10 (в первичной упаковке)


2021/6/6 15:32




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-10 (во вторичной упаковке)

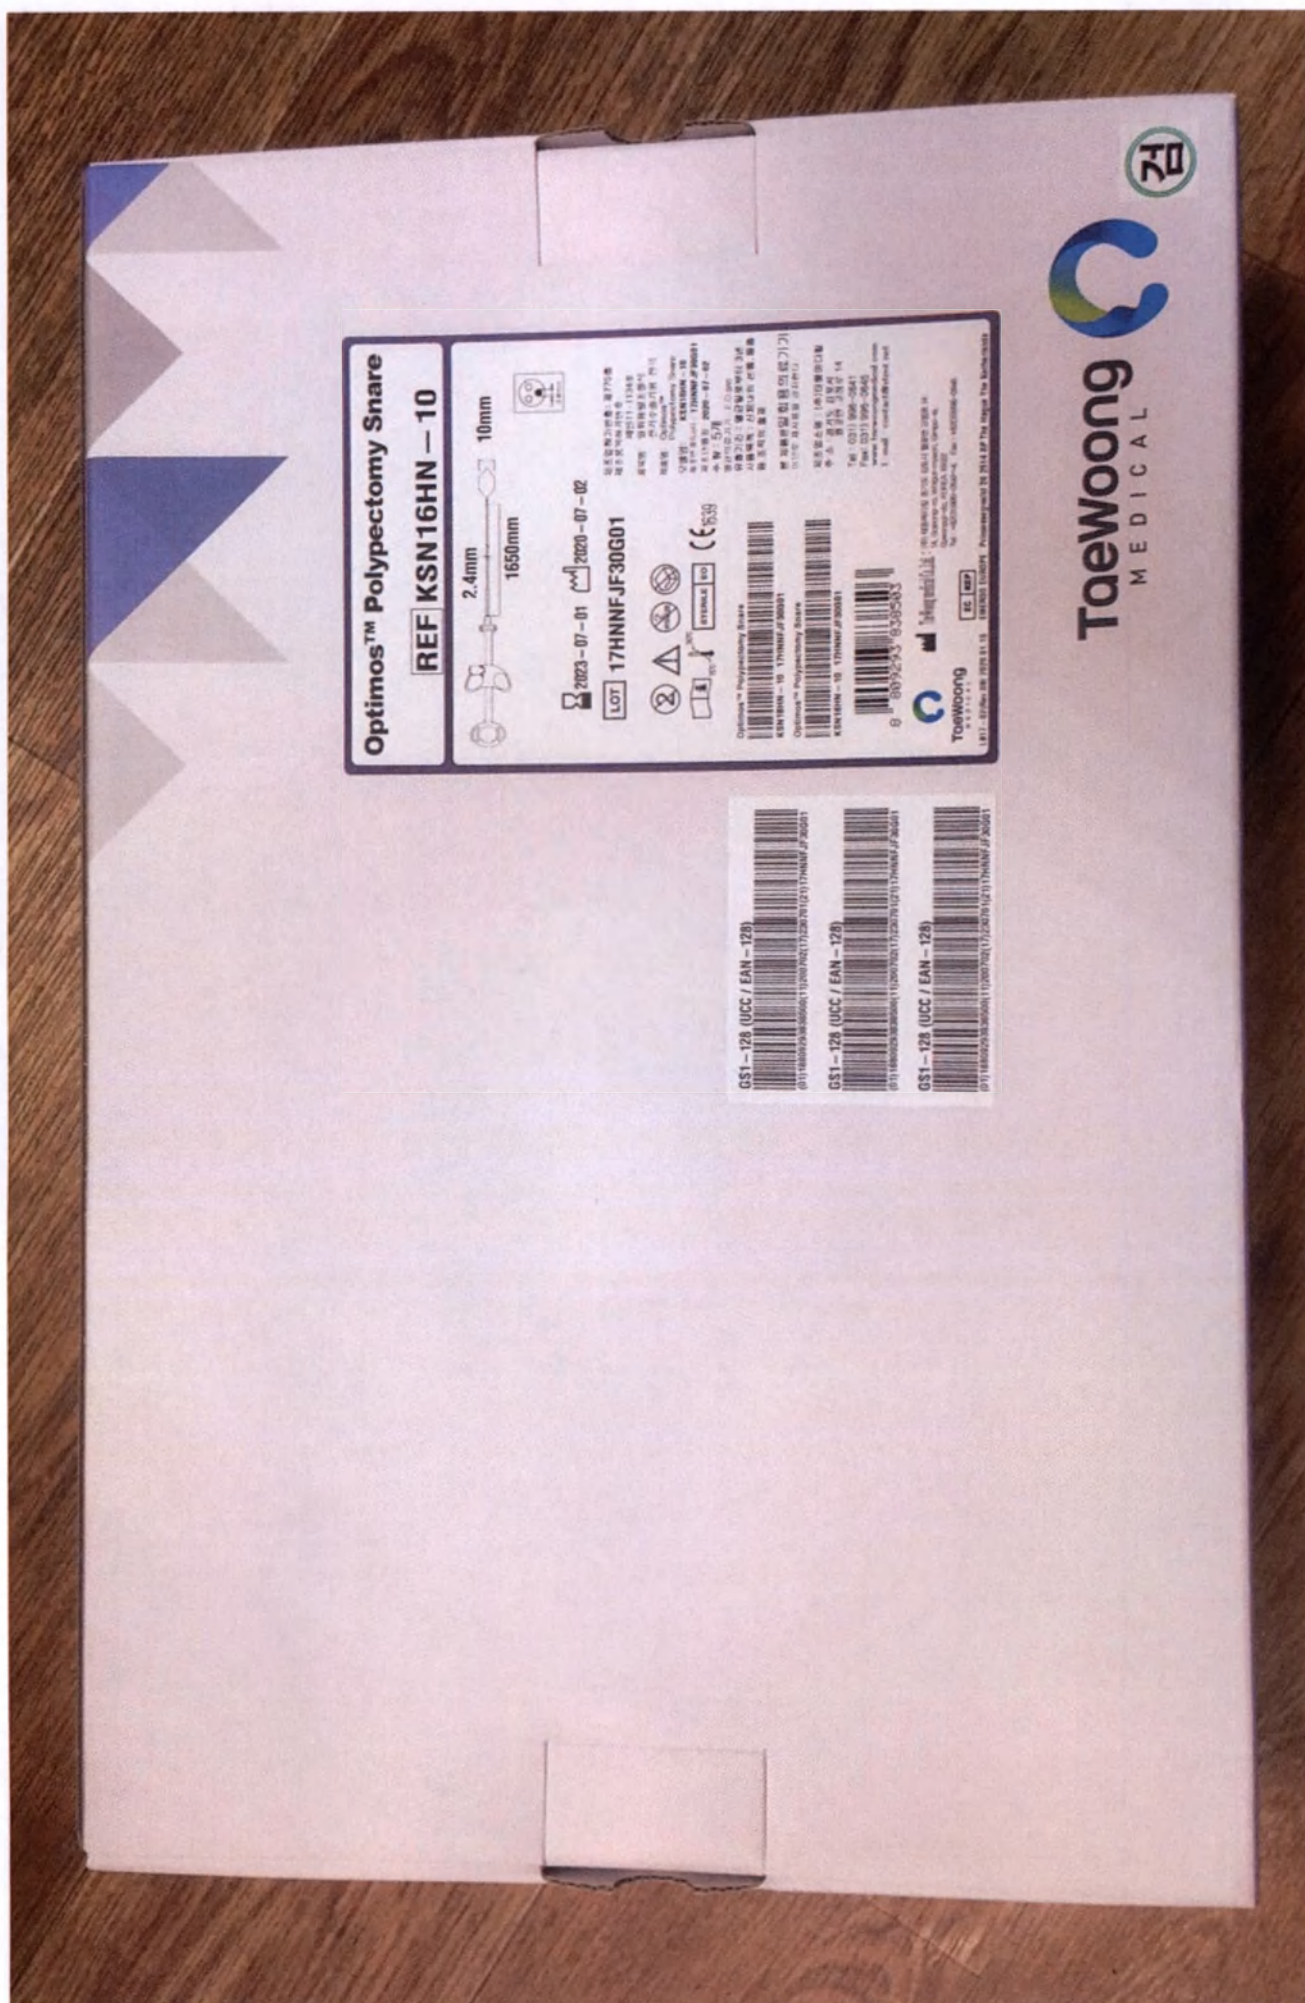

2021/6/6 15:42

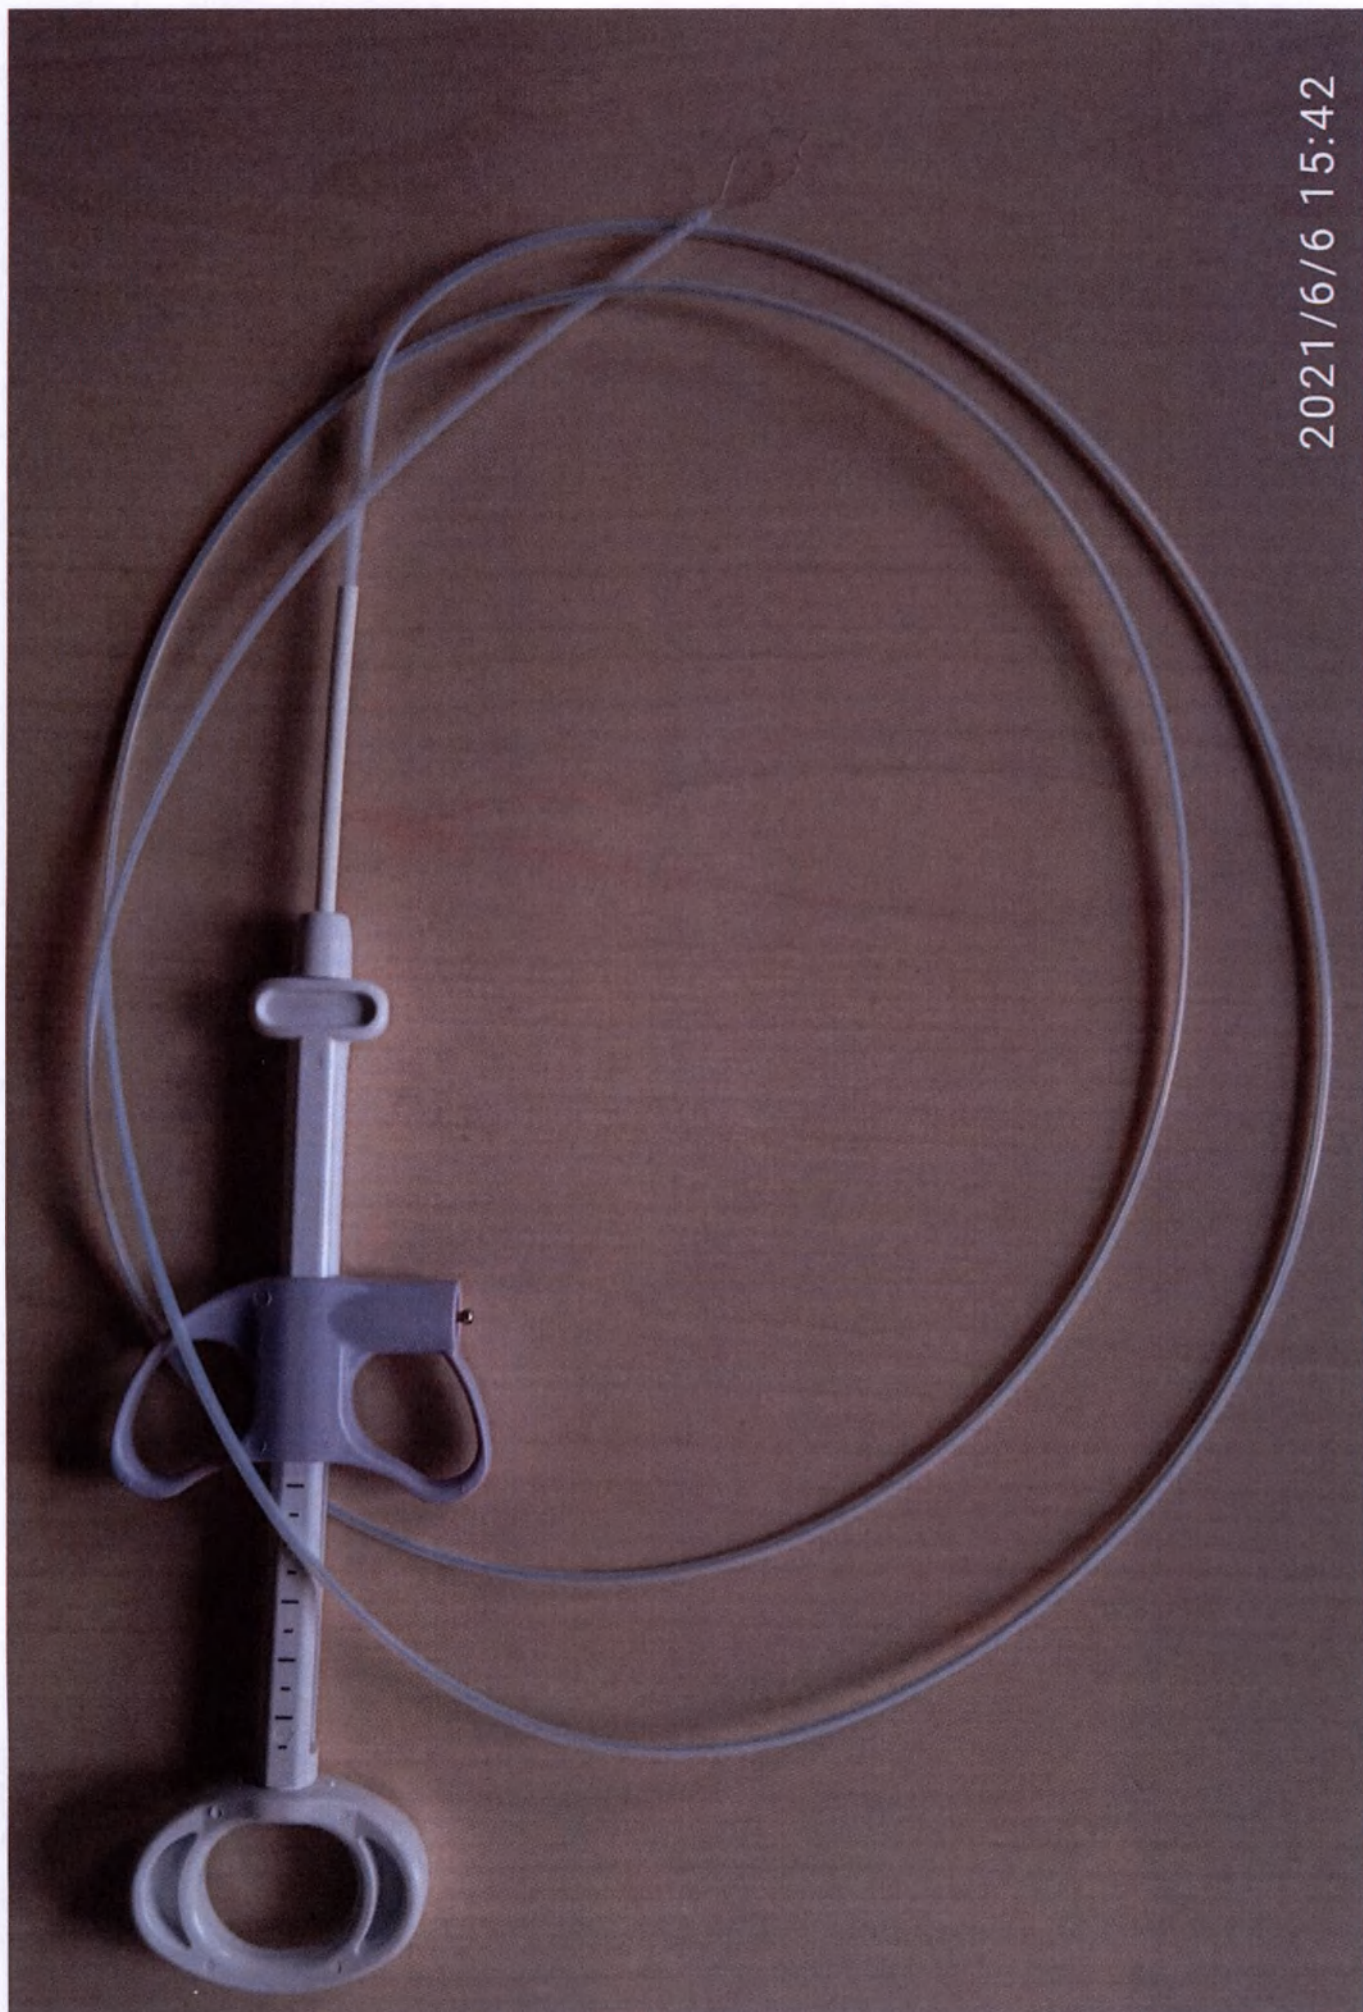

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-10 (в первичной упаковке)

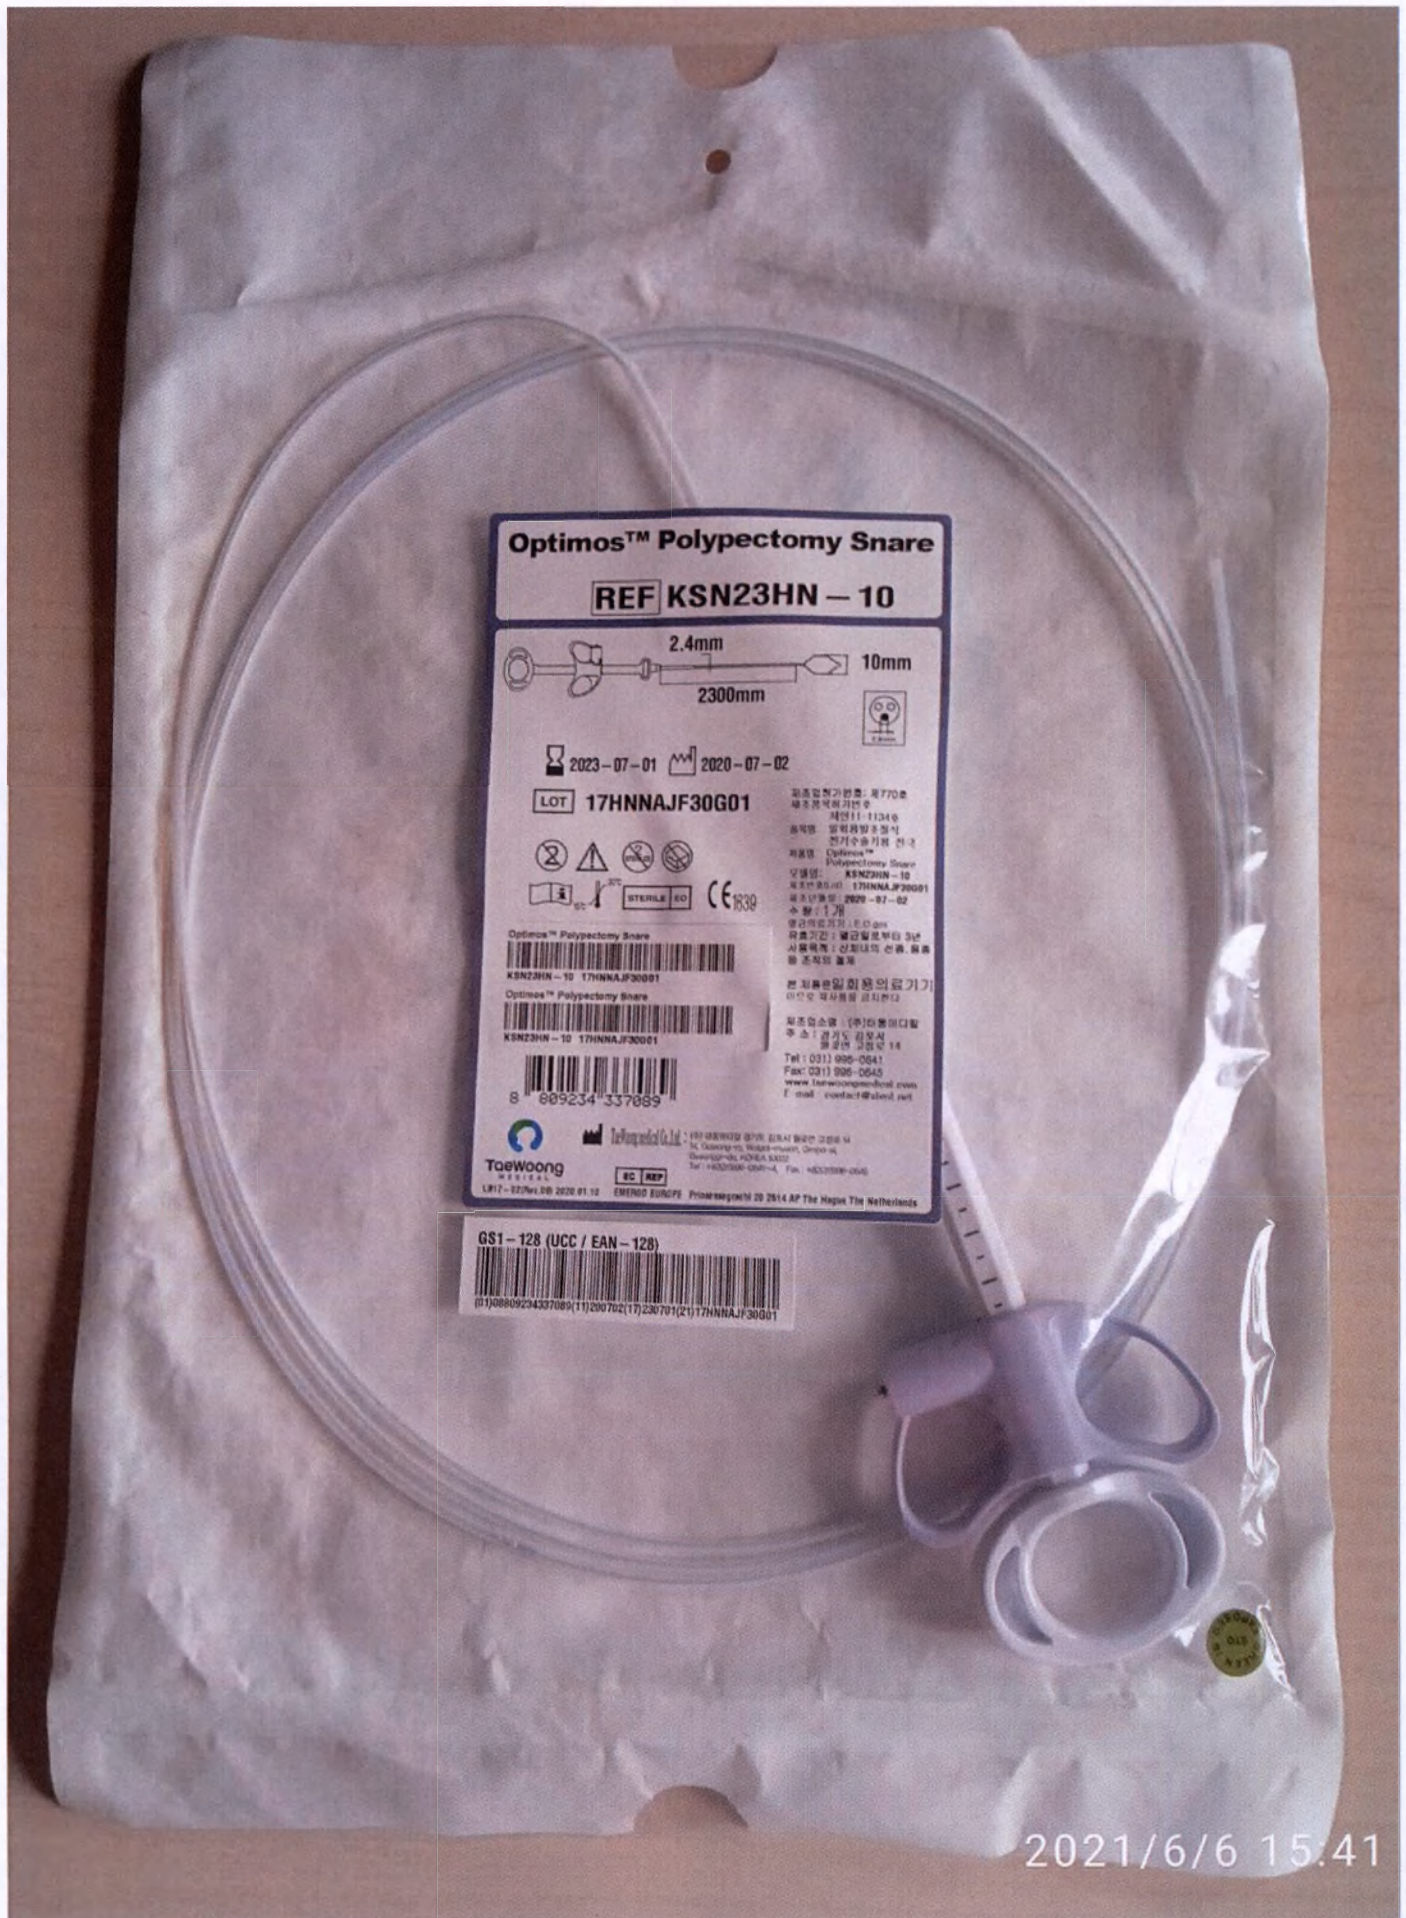

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-10 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-15



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-15 (в первичной упаковке)



2021/6/6 15:50

Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN16HN - 15



2023-07-01 2020-07-02

LOT 17HNNJF30G01

STERILE EO CE 1639

Optimos™ Polypectomy Snare
KSN16HN - 15 17HNNJF30G01

Optimos™ Polypectomy Snare
KSN16HN - 15 17HNNJF30G01

8 809643 759946

TaeWoong MEDICAL


1817-87/Rev 00 2020 01 10 EMERGO EUROPE Promessestraat 20 2014 AP The Hague The Netherlands

GS1-128 (UCC / EAN-128)




(01)18809643759943(11)200702(17)230701(21)17HNNJF30G01

GS1-128 (UCC / EAN-128)



(01)18809643759943(11)200702(17)230701(21)17HNNJF30G01

GS1-128 (UCC / EAN-128)




(01)18809643759943(11)200702(17)230701(21)17HNNJF30G01

TaeWoong
MEDICAL



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-15

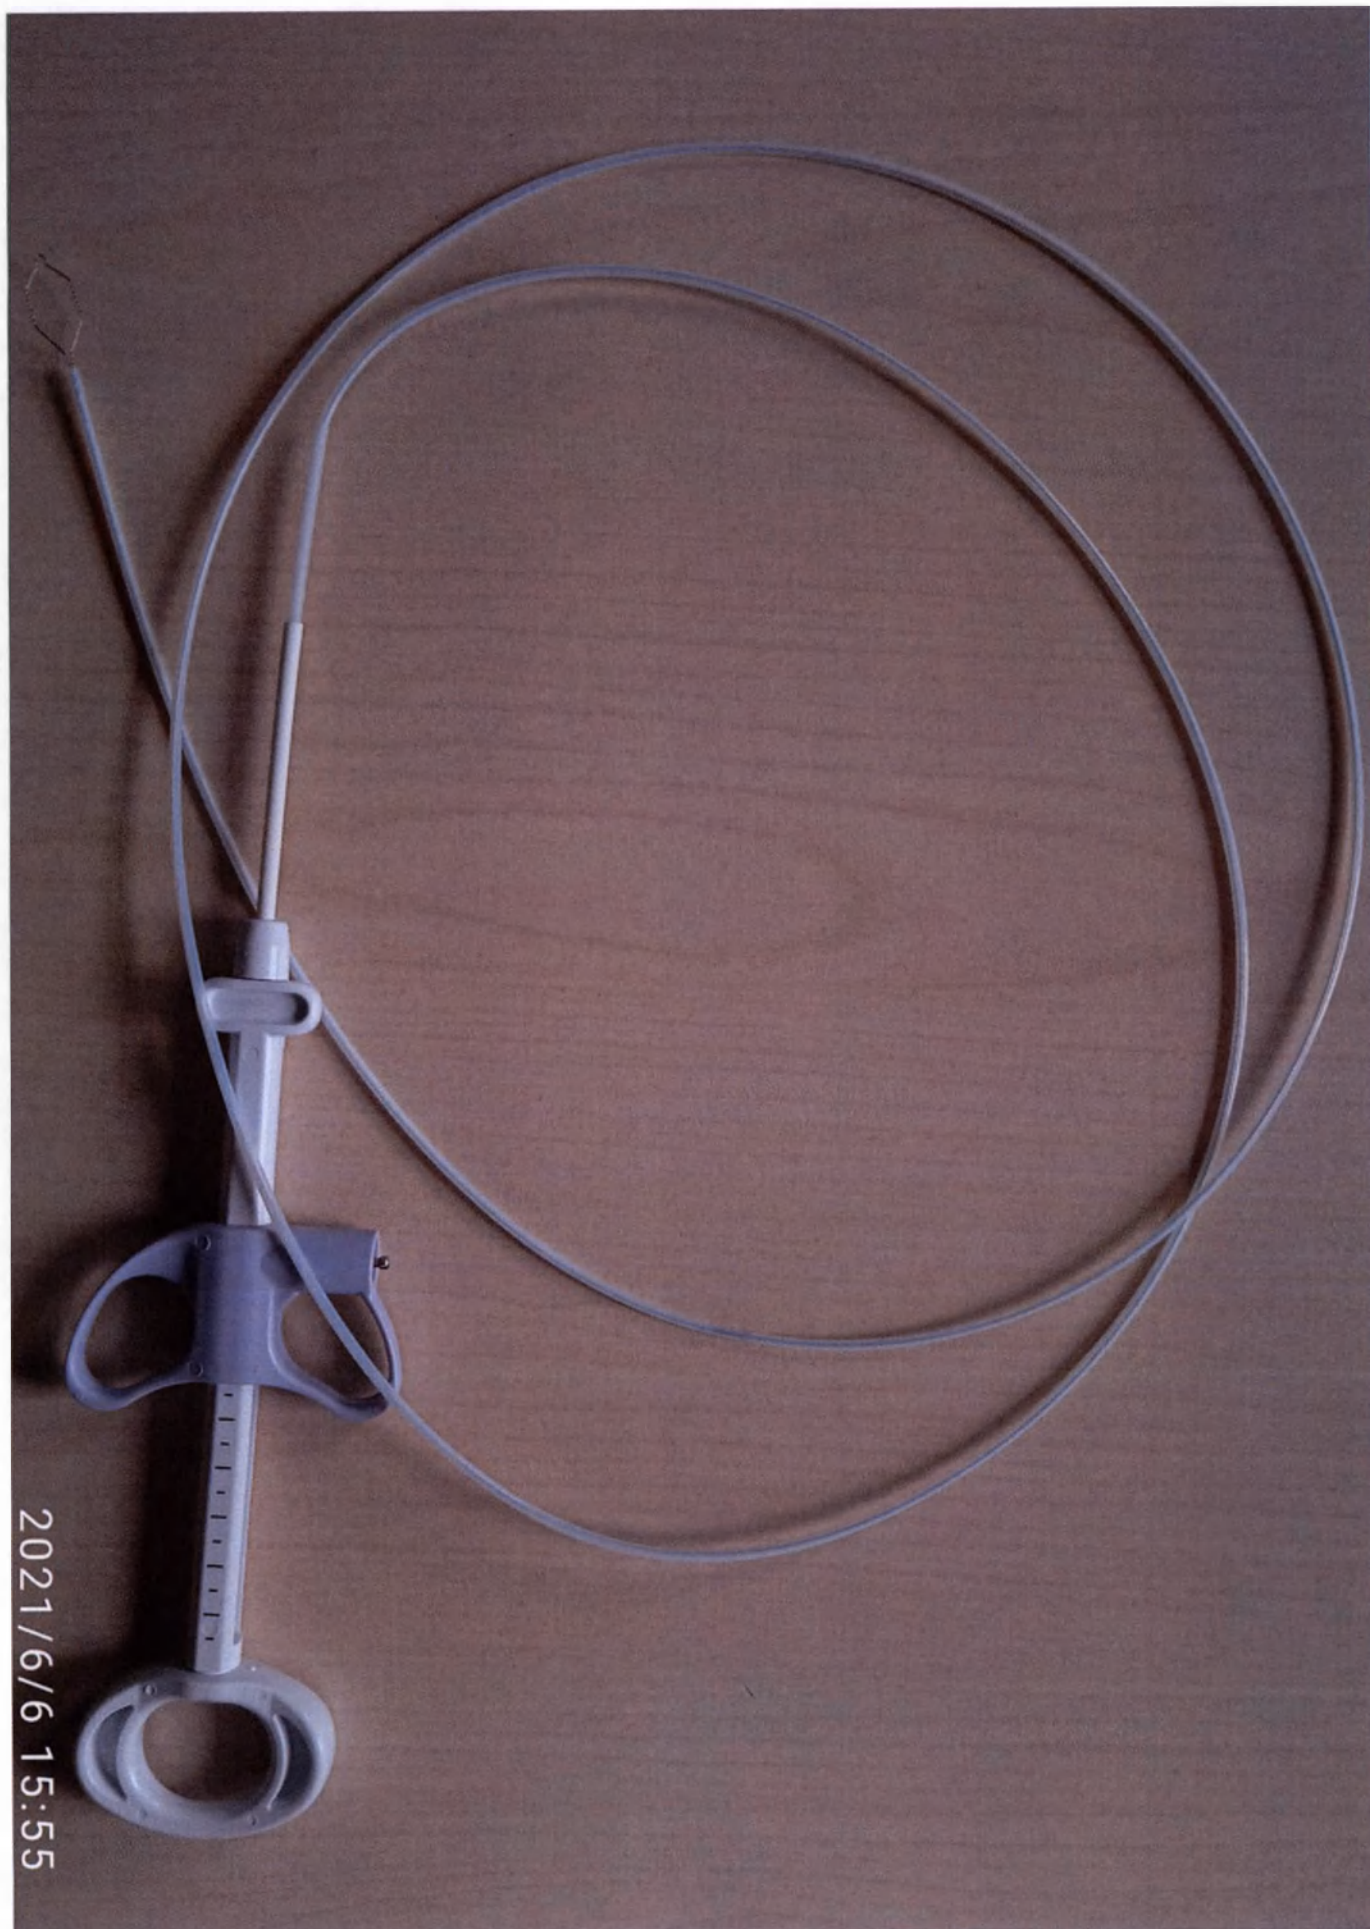

2021/6/6 15:55

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-15 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-10 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-20



2021/6/6 15:50

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-20 (в первичной упаковке)


2021/6/6 15:58



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-20 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-20

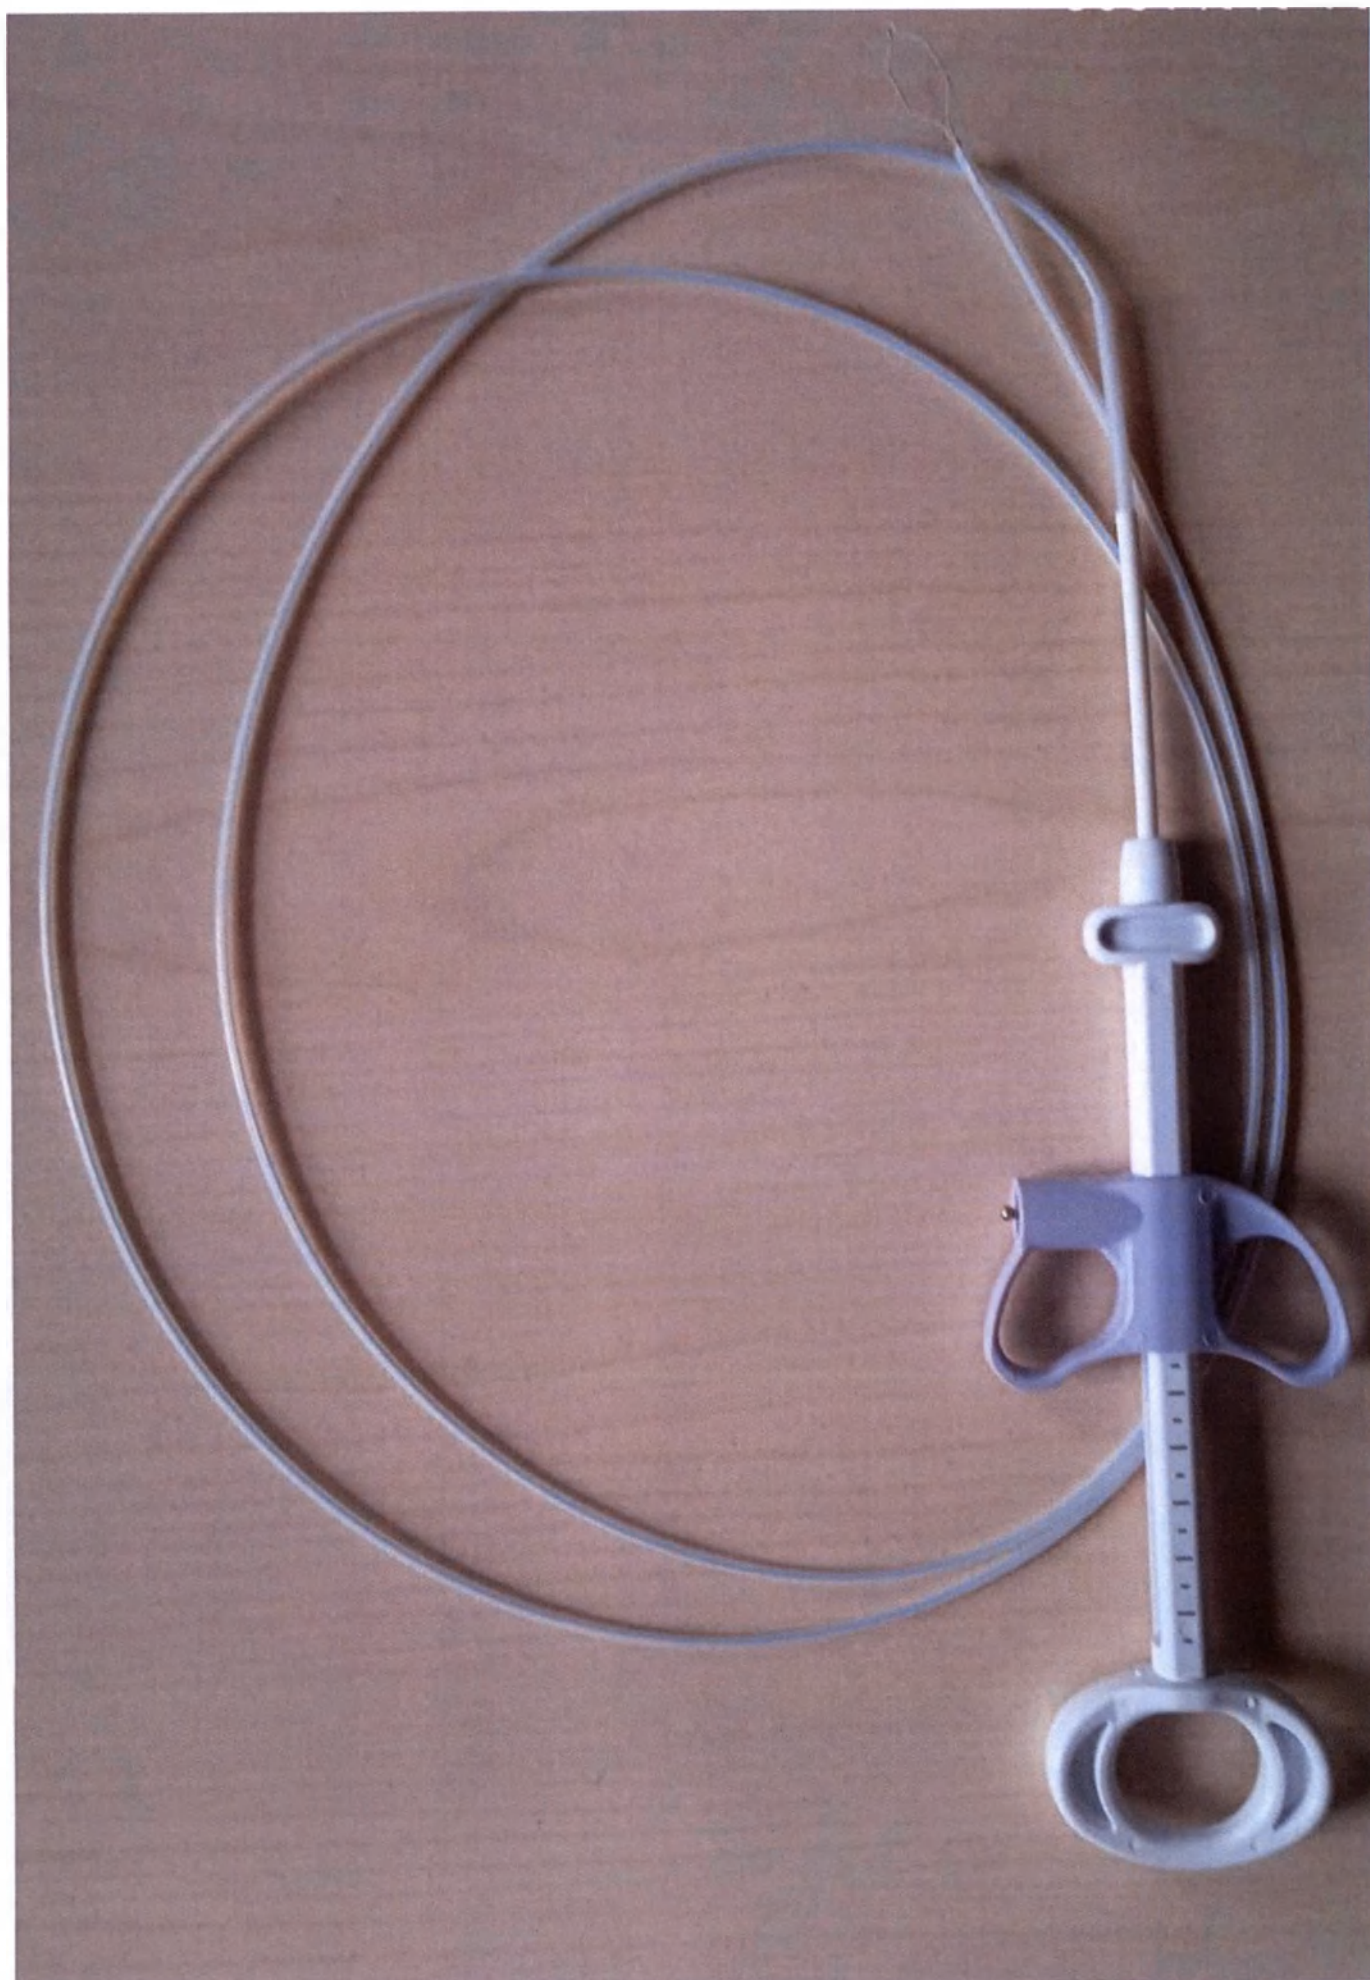


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-20 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-20 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-25

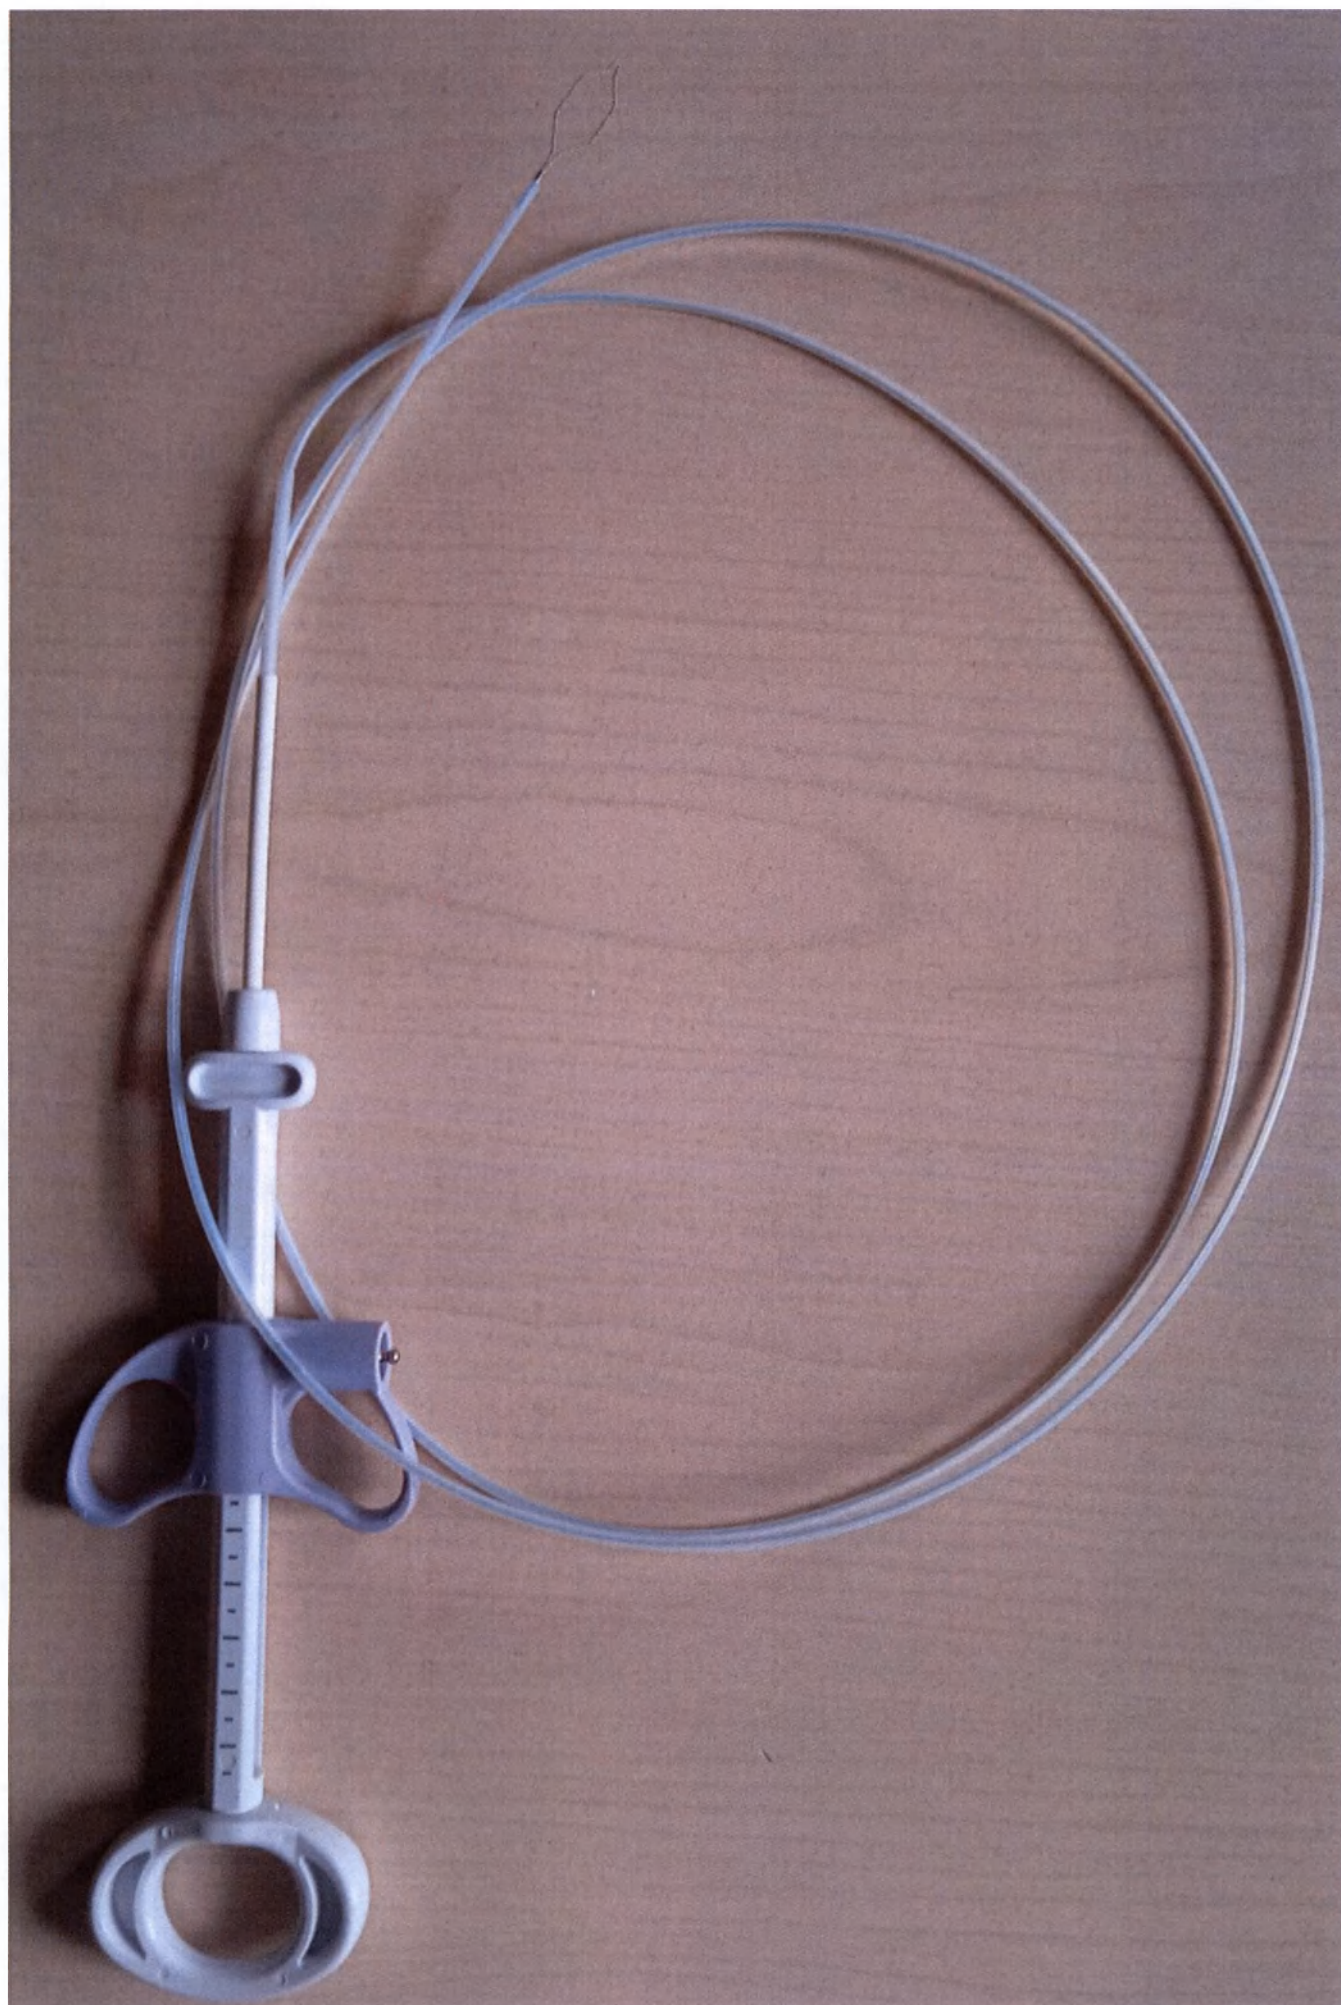


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-25 (в первичной упаковке)




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-25 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23HN-25

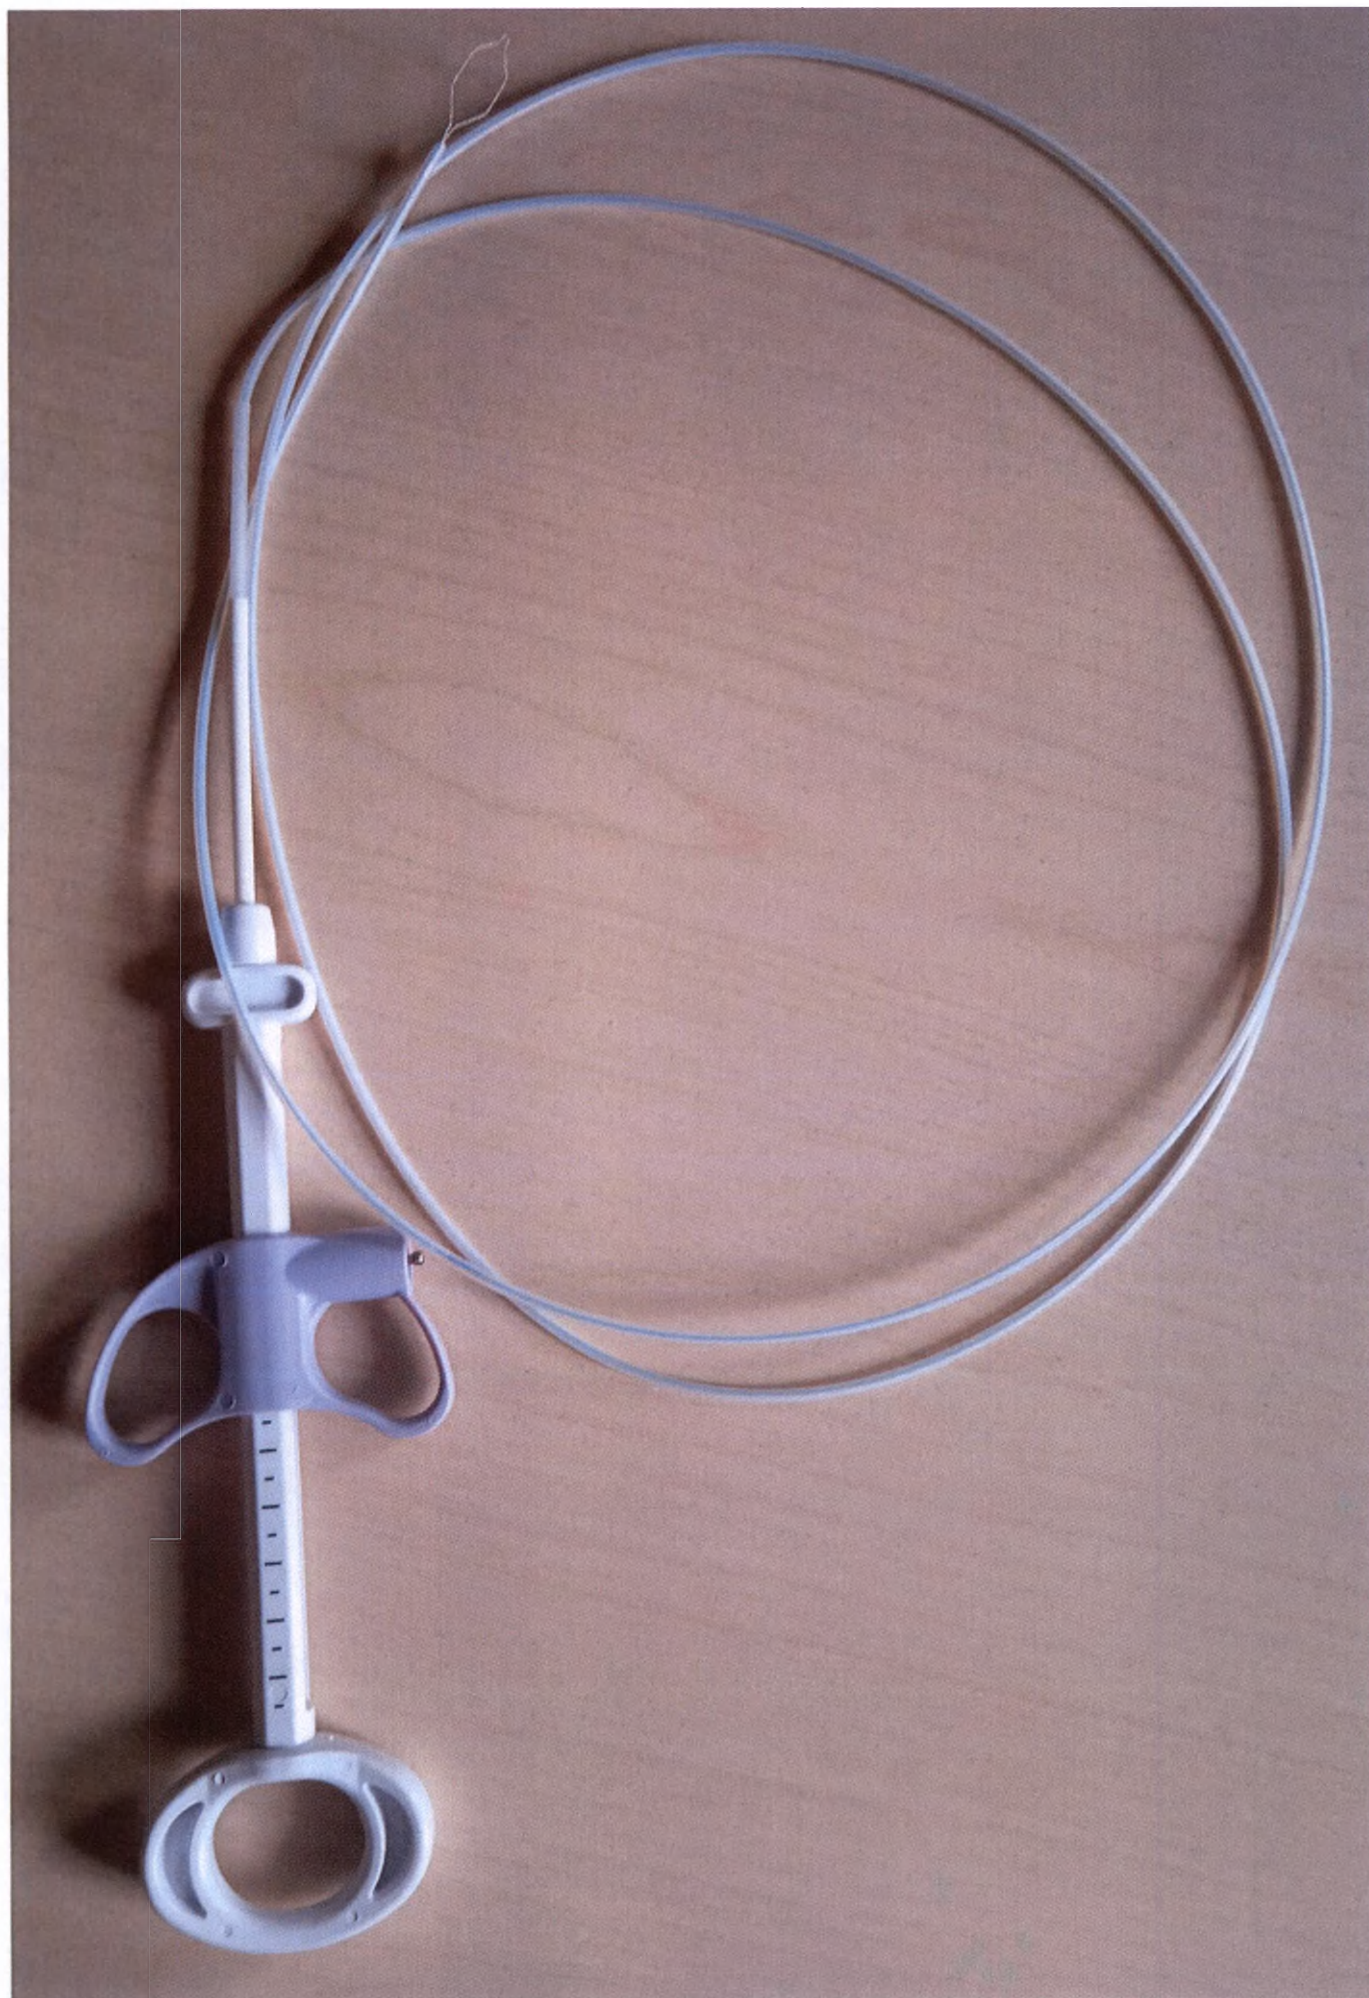

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-25 (в первичной упаковке)

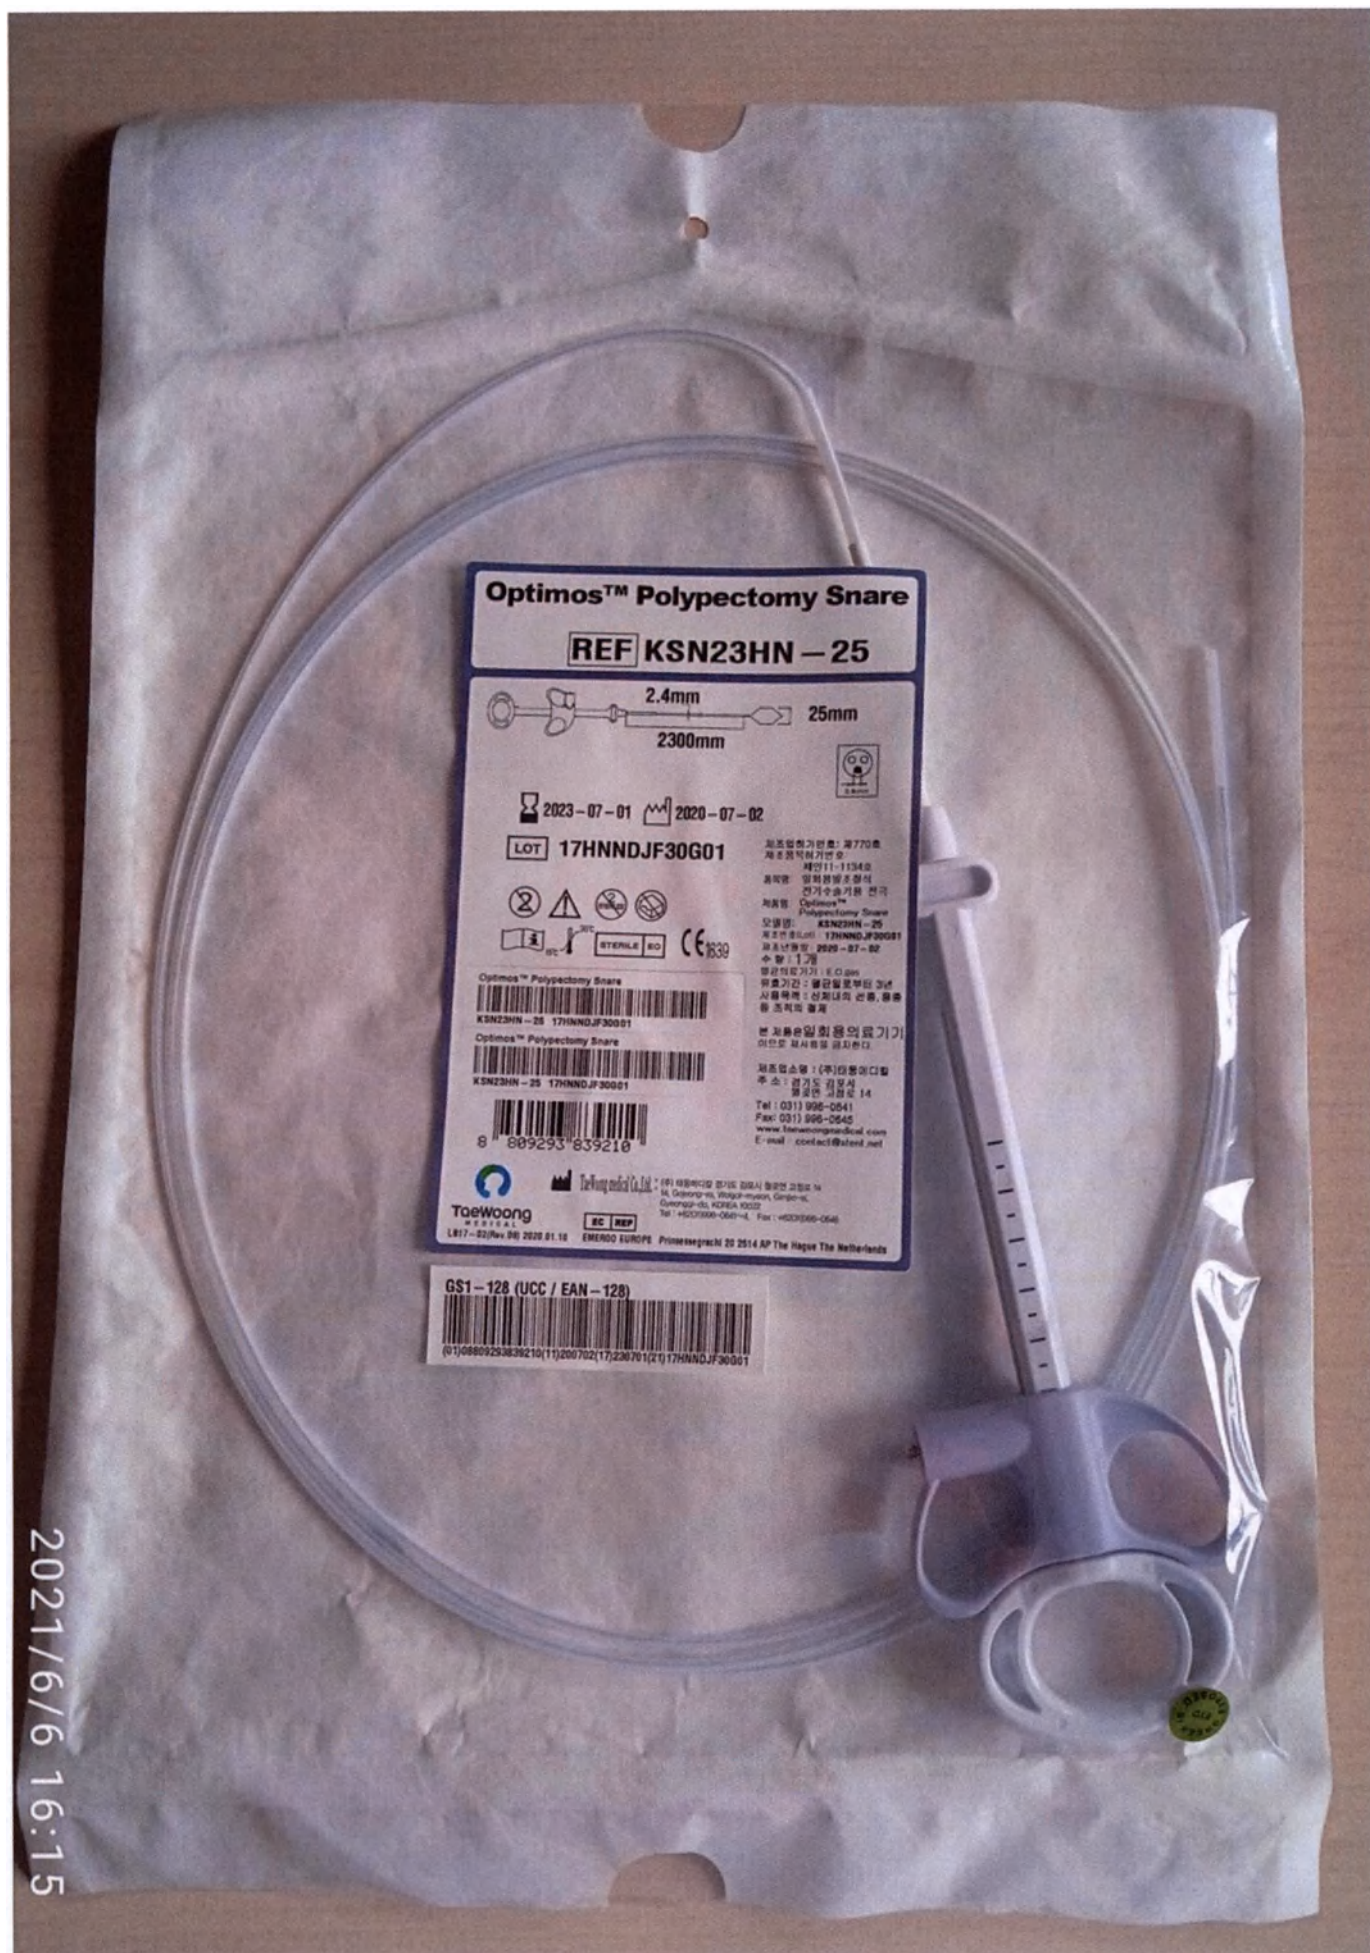

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-25 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-30




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16HN-30 (в первичной упаковке)




Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN16HN — 30



2023-07-01 2020-07-02

LOT 17HNNJJF30G01



Optimos™ Polypectomy Snare

KSN16HN — 30 17HNNJJF30G01

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN16HN — 30 17HNNJJF30G01



8 809643 759793



TaeWoong MEDICAL

LOT 17HNNJJF30G01

TaeWoong Medical Co., Ltd. 101 HEMPHILL RD, GYEONGGI-DO, SUJEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA 10027
Tel: +82(0)31-998-0641 Fax: +82(0)31-998-0645
www.taewoongmedical.com E-mail: ccooact@tmed.net

CE MDP EN17-01 Rev B1 2024 01 10 EN17001:2015 2014 AP The Hague The Netherlands

GS1-128 (UCC / EAN-128)



(01)18809643759790(11)200702(17)230701(21)17HNNJJF30G01

GS1-128 (UCC / EAN-128)



(01)18809643759790(11)200702(17)230701(21)17HNNJJF30G01

GS1-128 (UCC / EAN-128)




(01)18809643759790(11)200702(17)230701(21)17HNNJJF30G01

TaeWoong MEDICAL




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-30

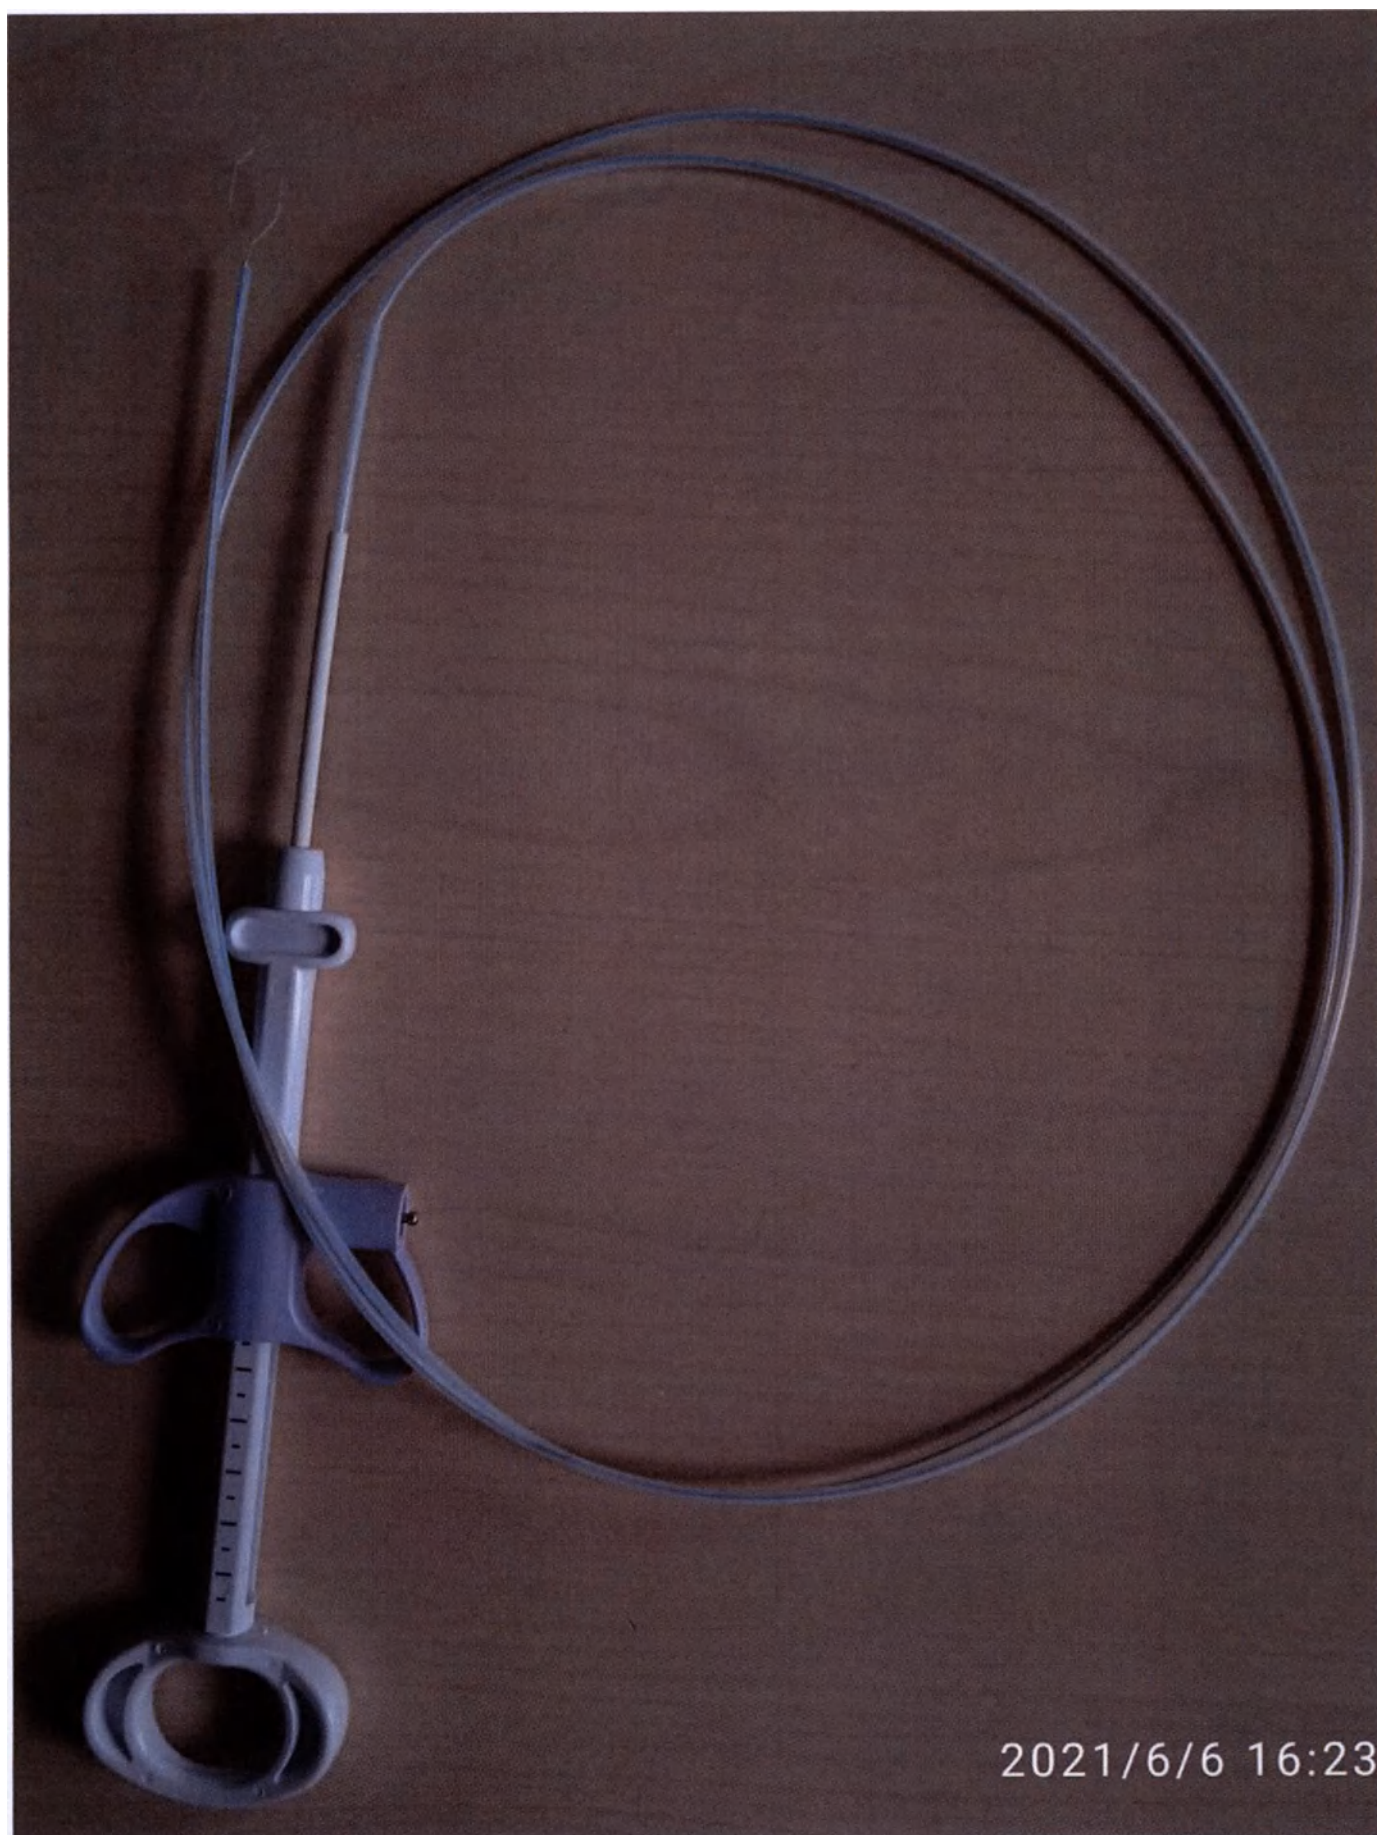


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23HN-30 (в первичной упаковке)



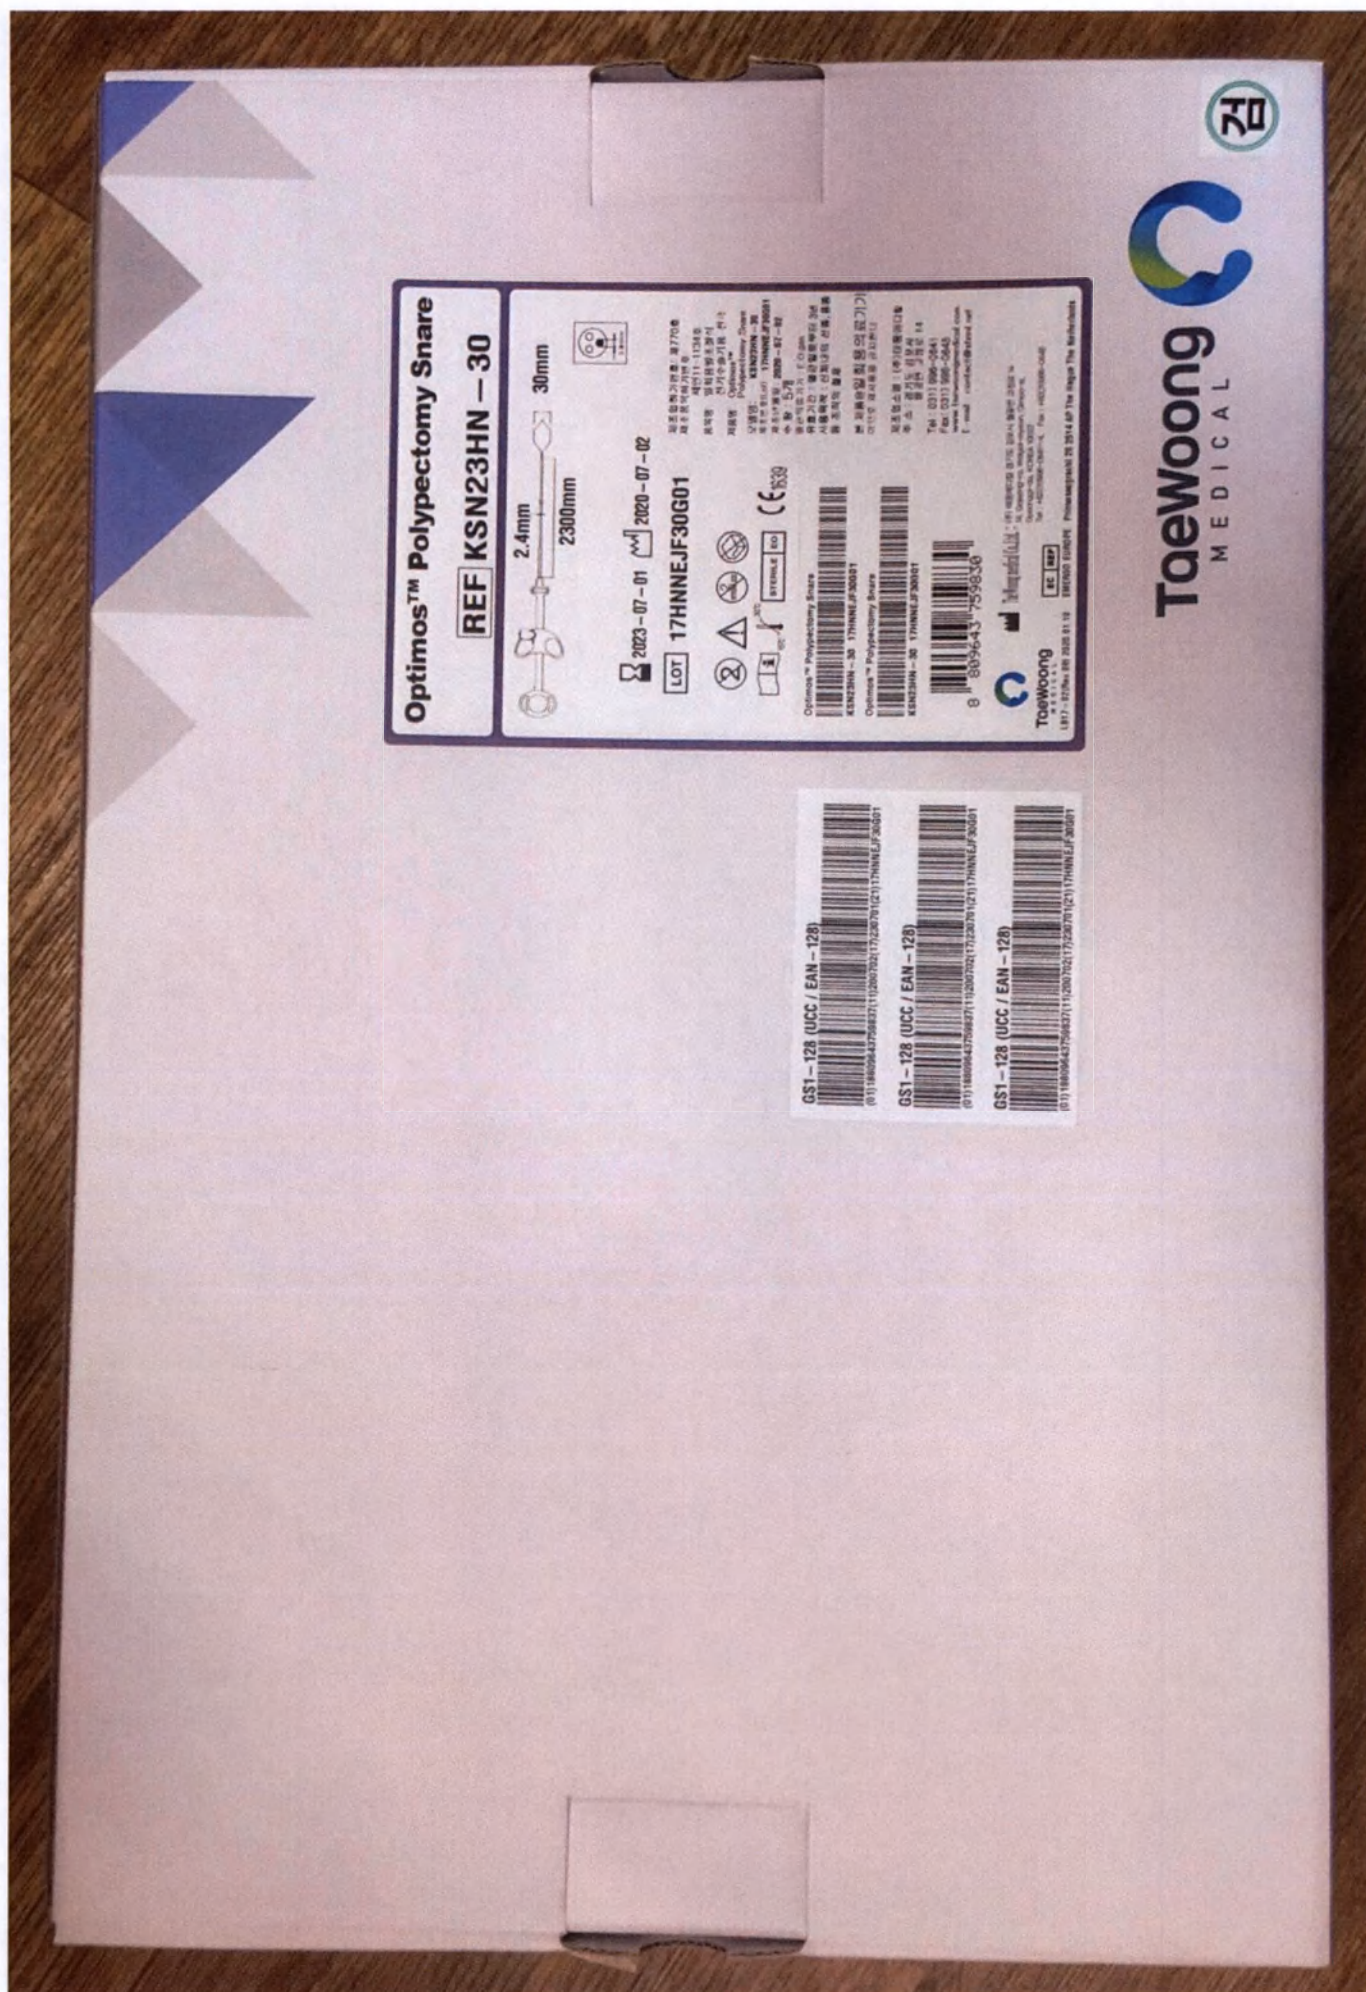

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16DN-15

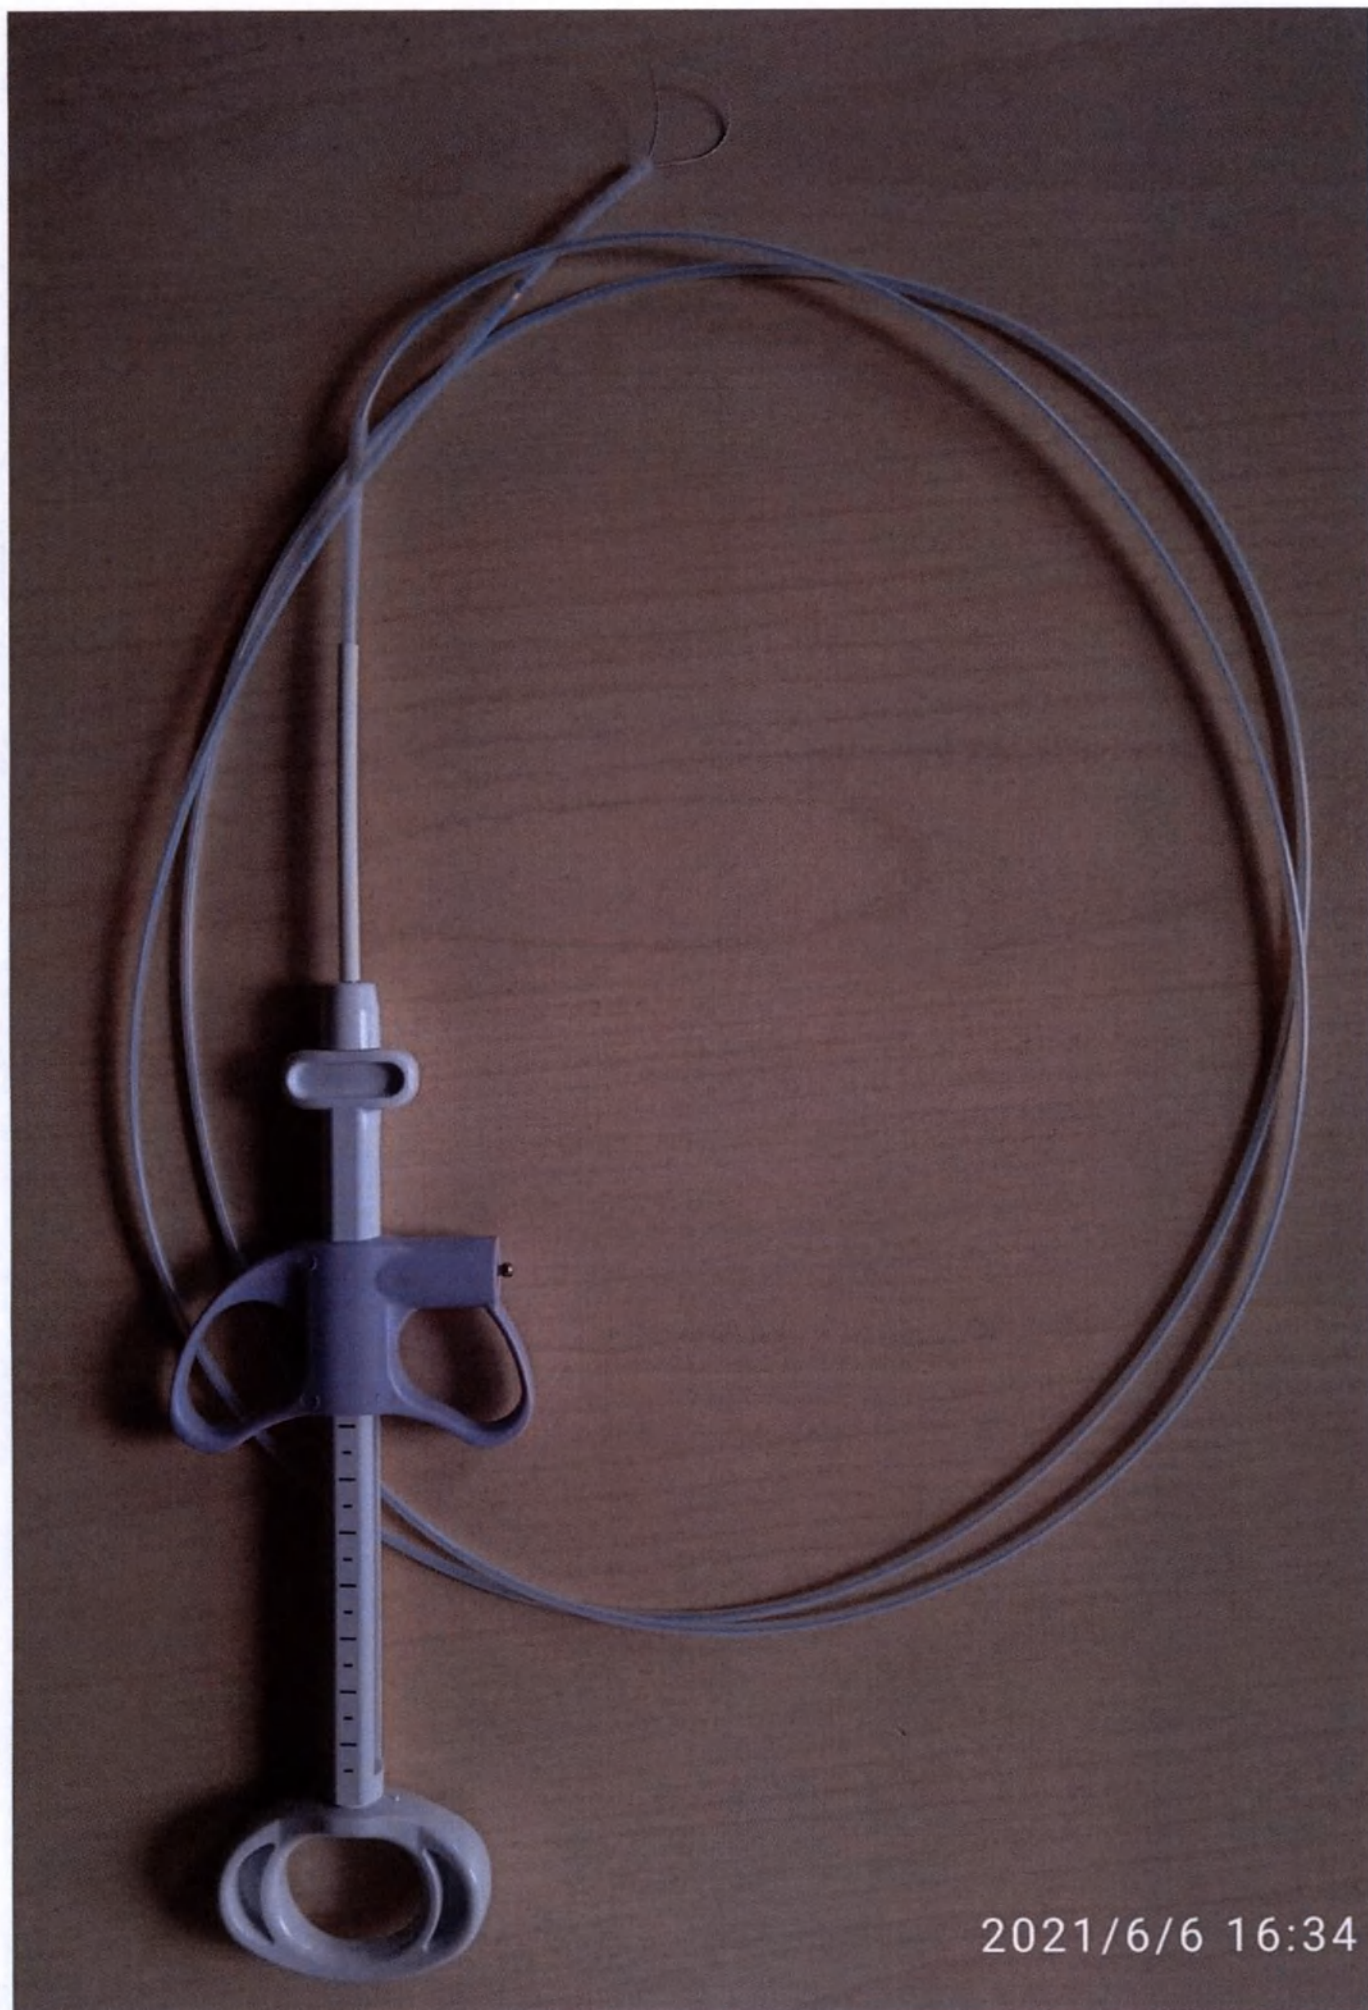


2021/6/6 16:34


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16DN-15 (в первичной упаковке)



2021/6/6 16:32

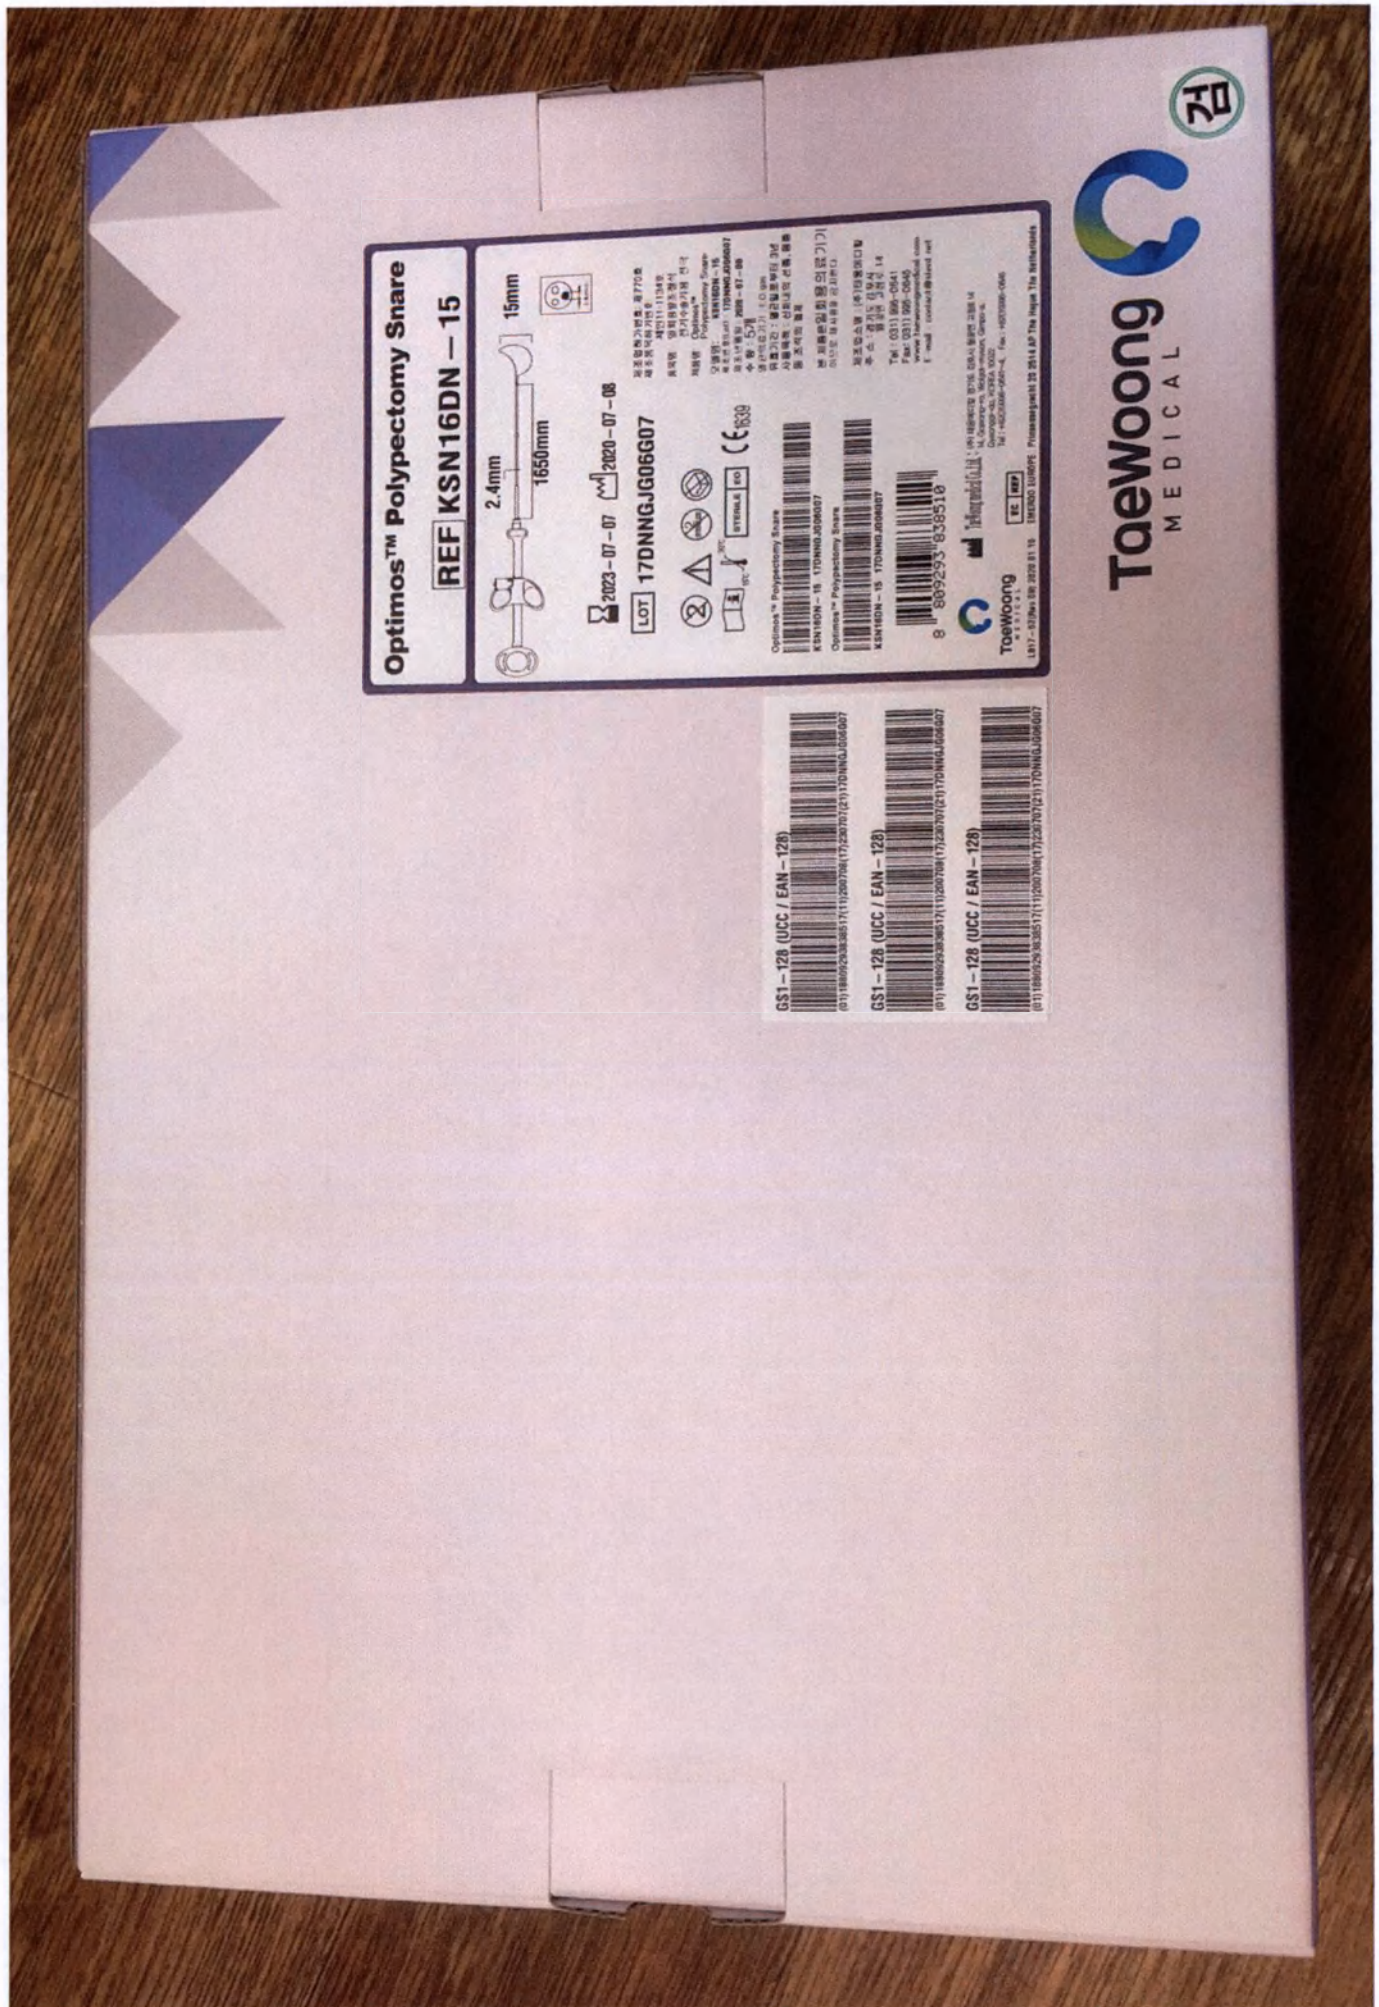

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23DN-15

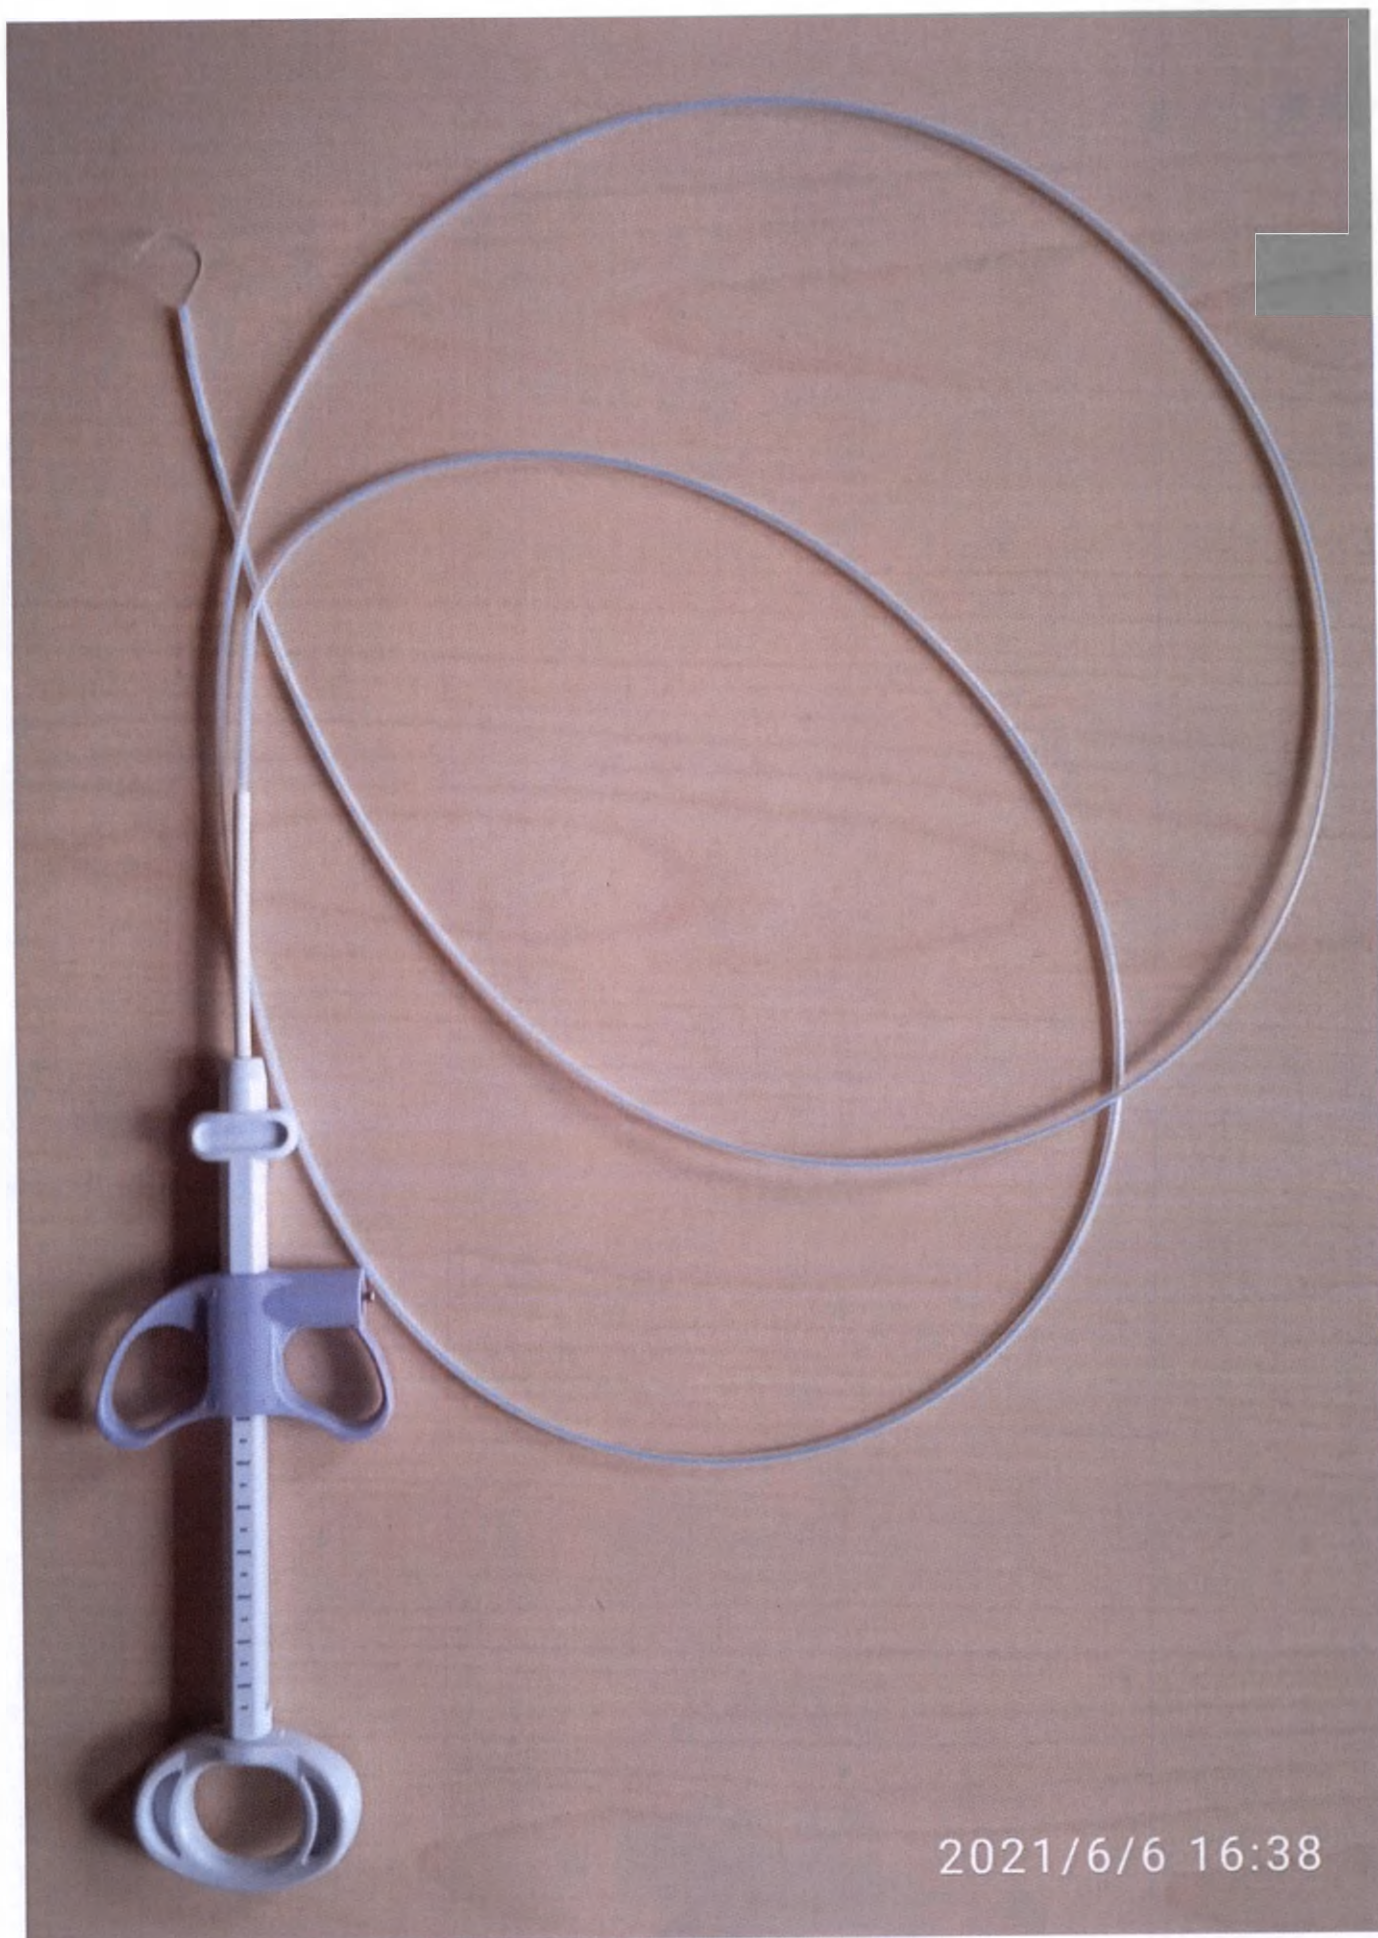

Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN23DN-15

2.4mm
 15mm
 2300mm

2023-07-07 2020-07-08
LOT 17DNNBJG06G07

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23DN-15 17DNNBJG06G07

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23DN-15 17DNNBJG06G07

8 009293 850626


TaeWoong MEDICAL
 1817-87288 200 2020 01 10


GS1-128 (UCC / EAN-128)
 0 009293 850626 1 17DNNBJG06G07

2021/6/6 16:37

2021/6/6 16:37

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23DN-15 (во вторичной упаковке)

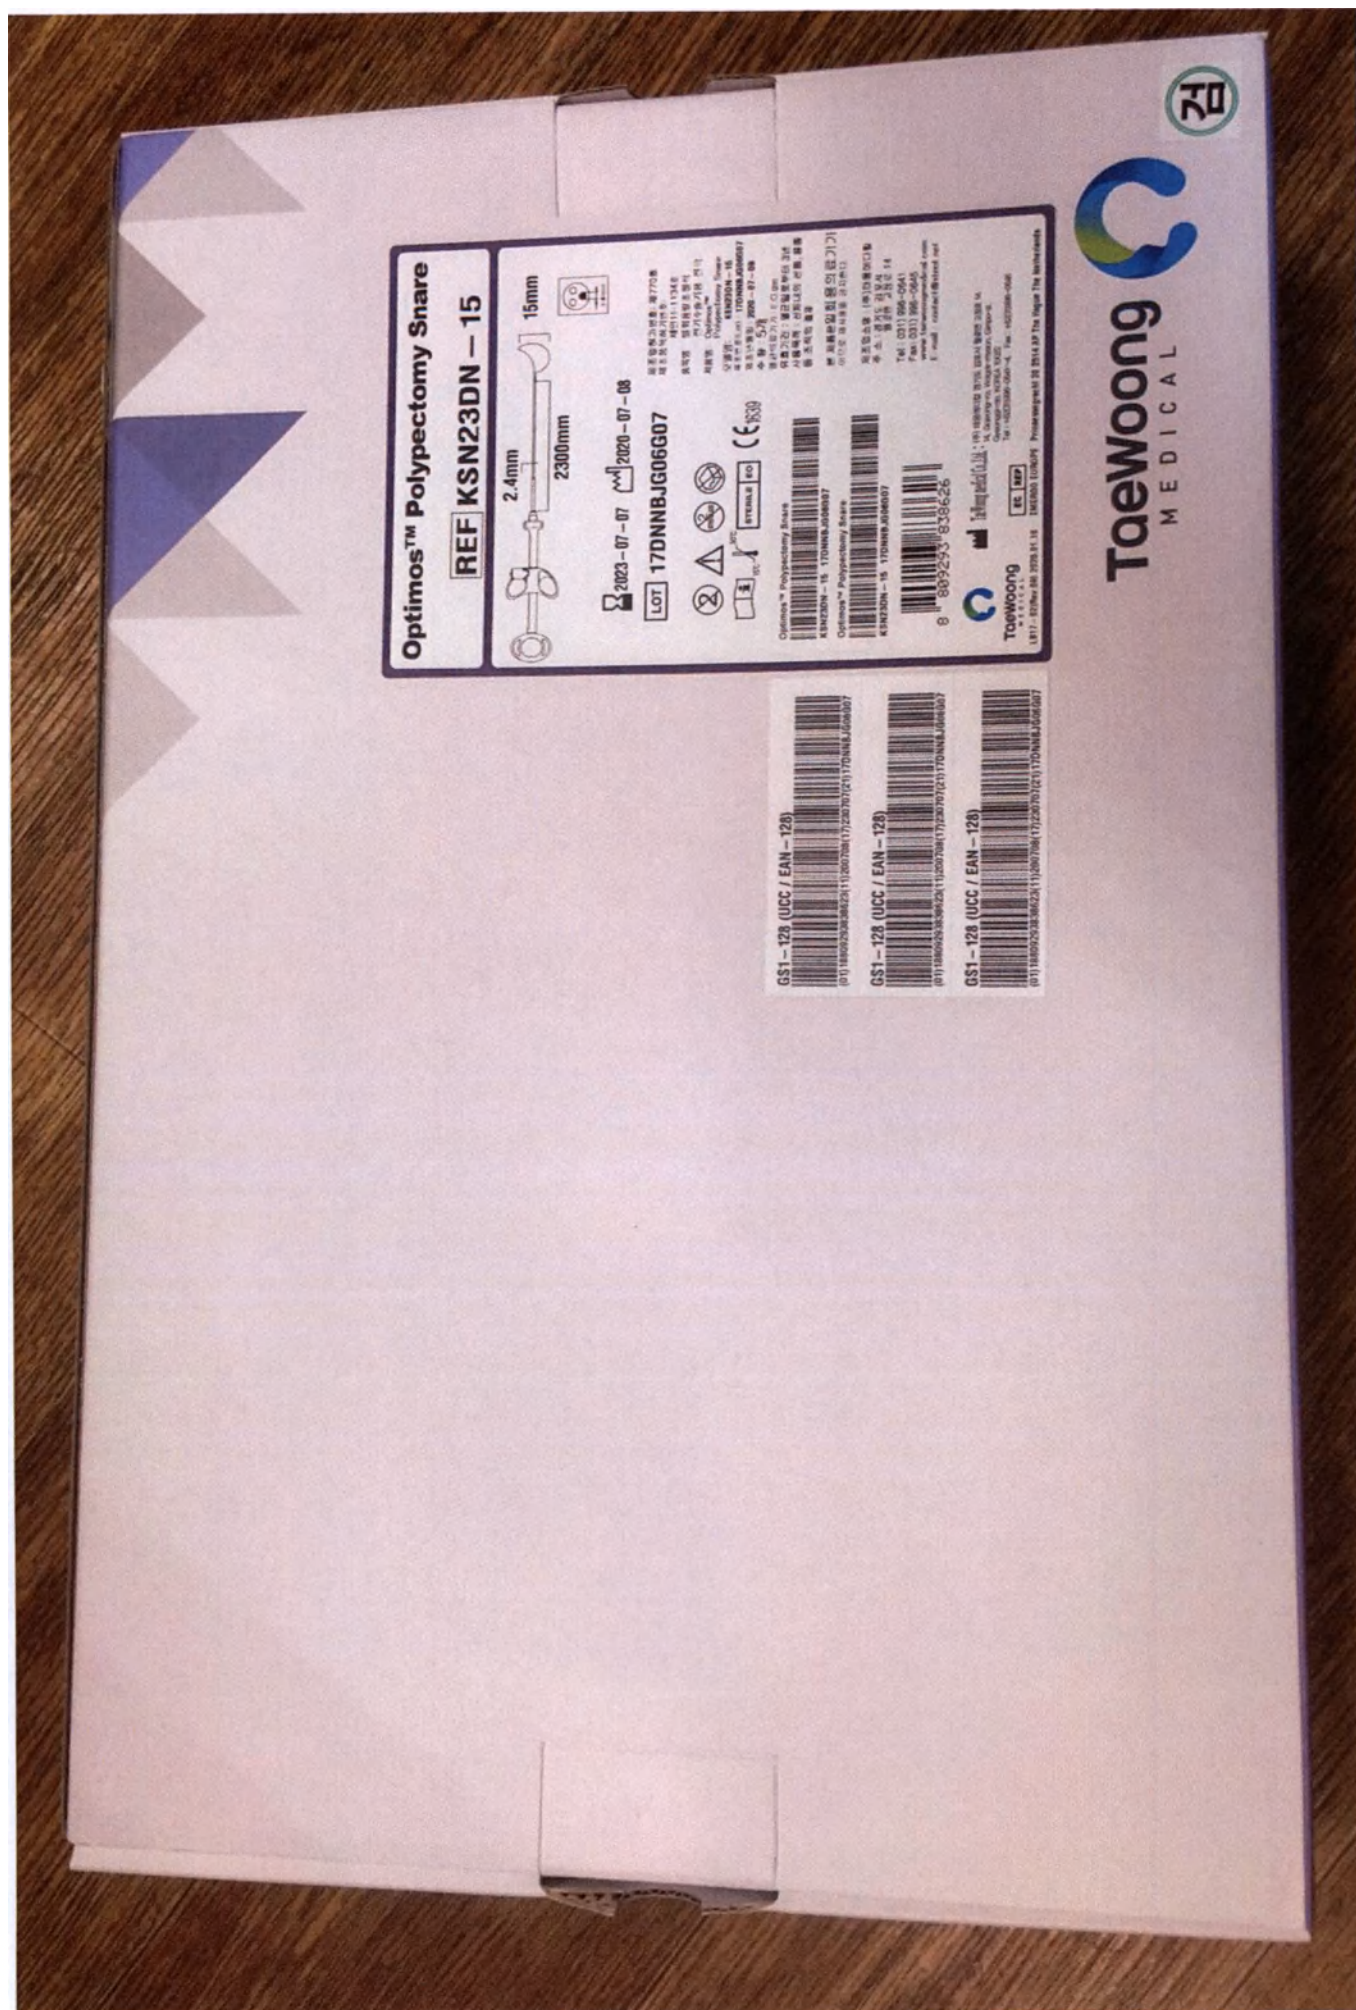

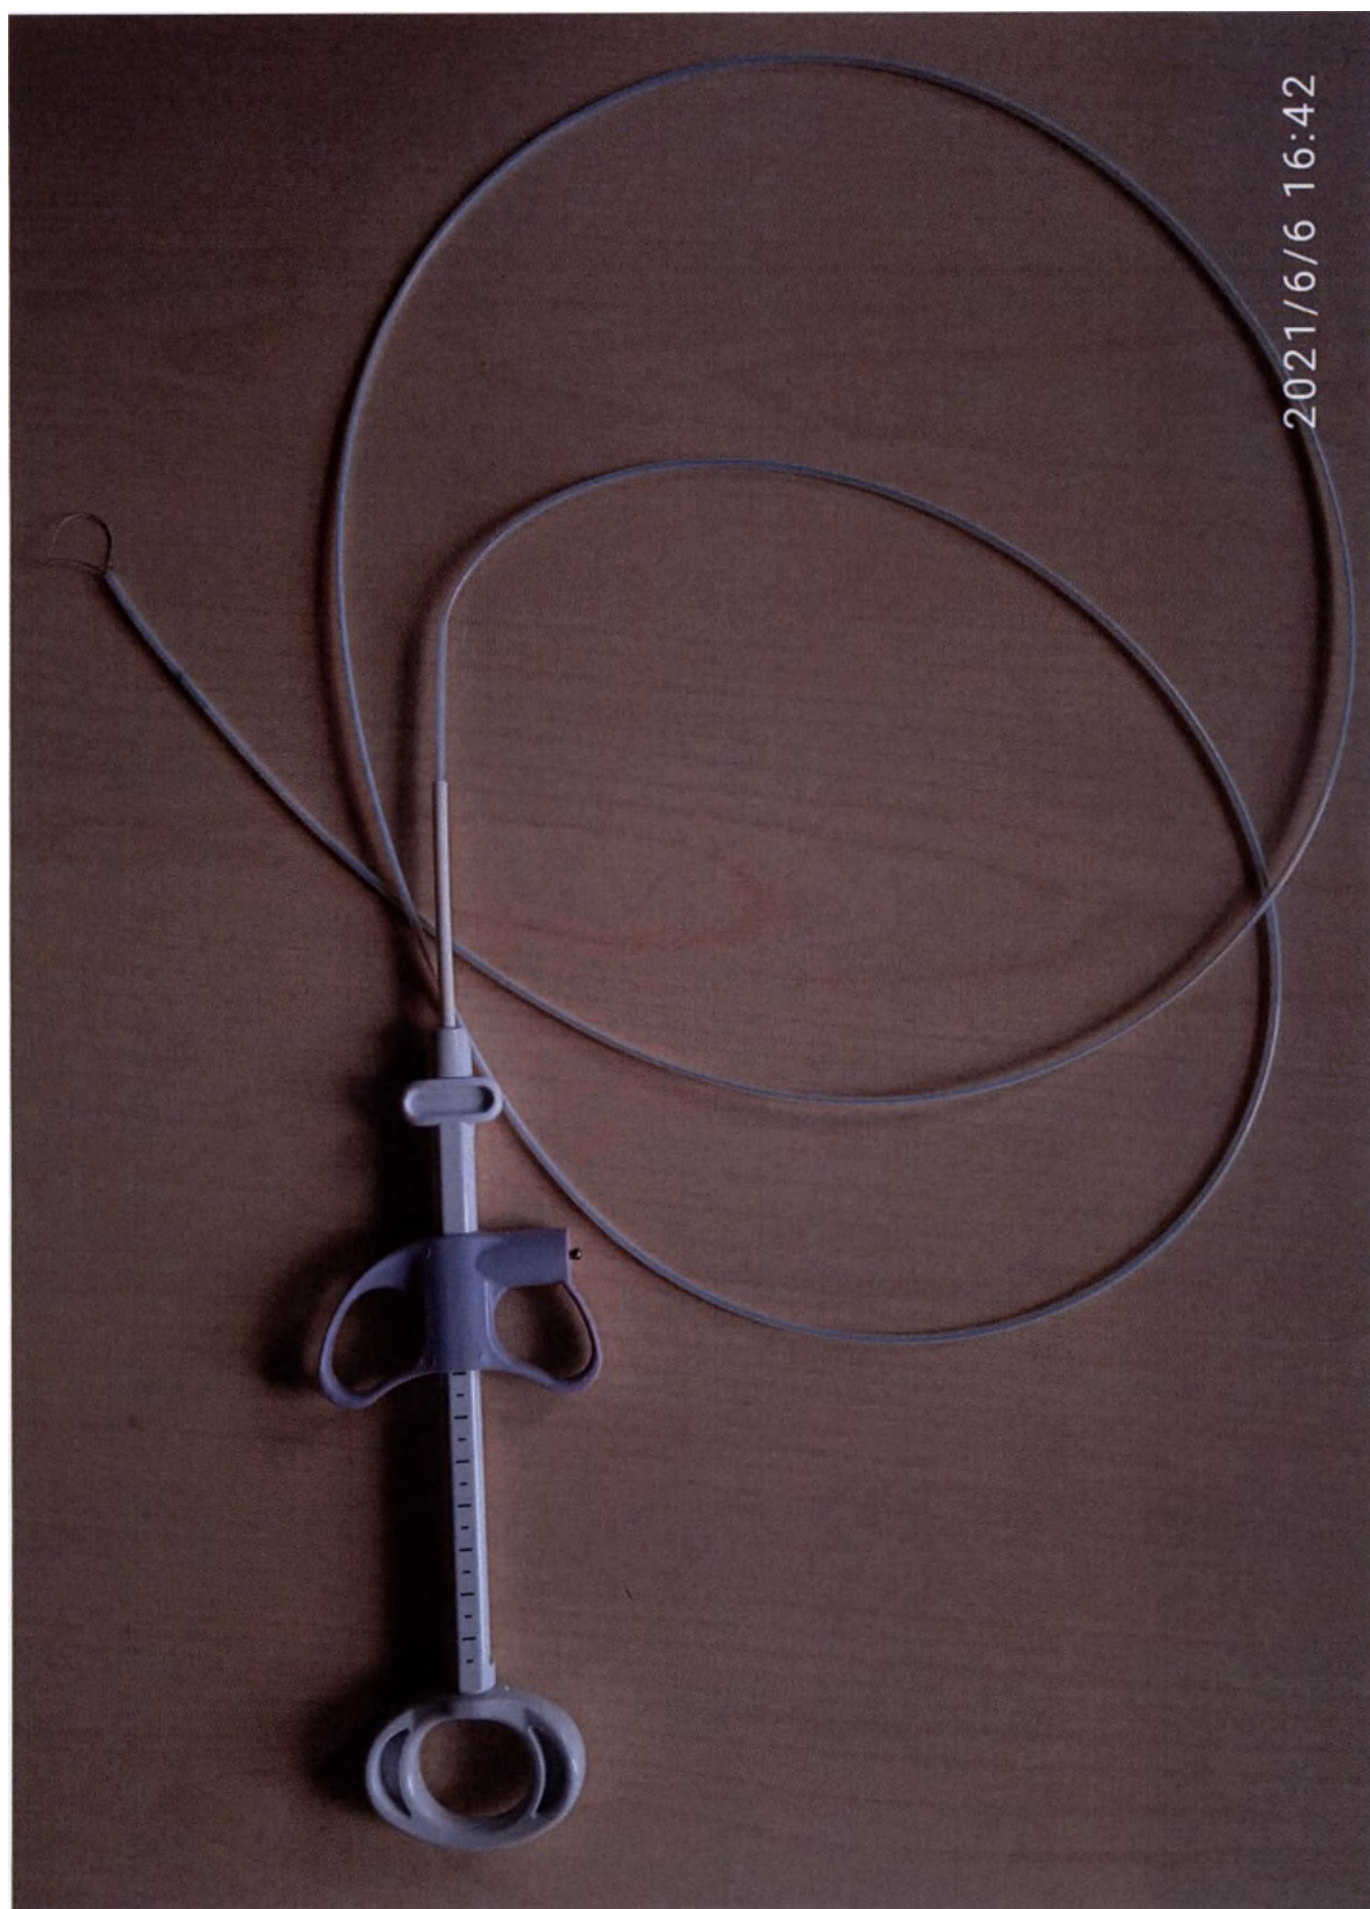


Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16DN-25 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16DN-25 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23DN-25

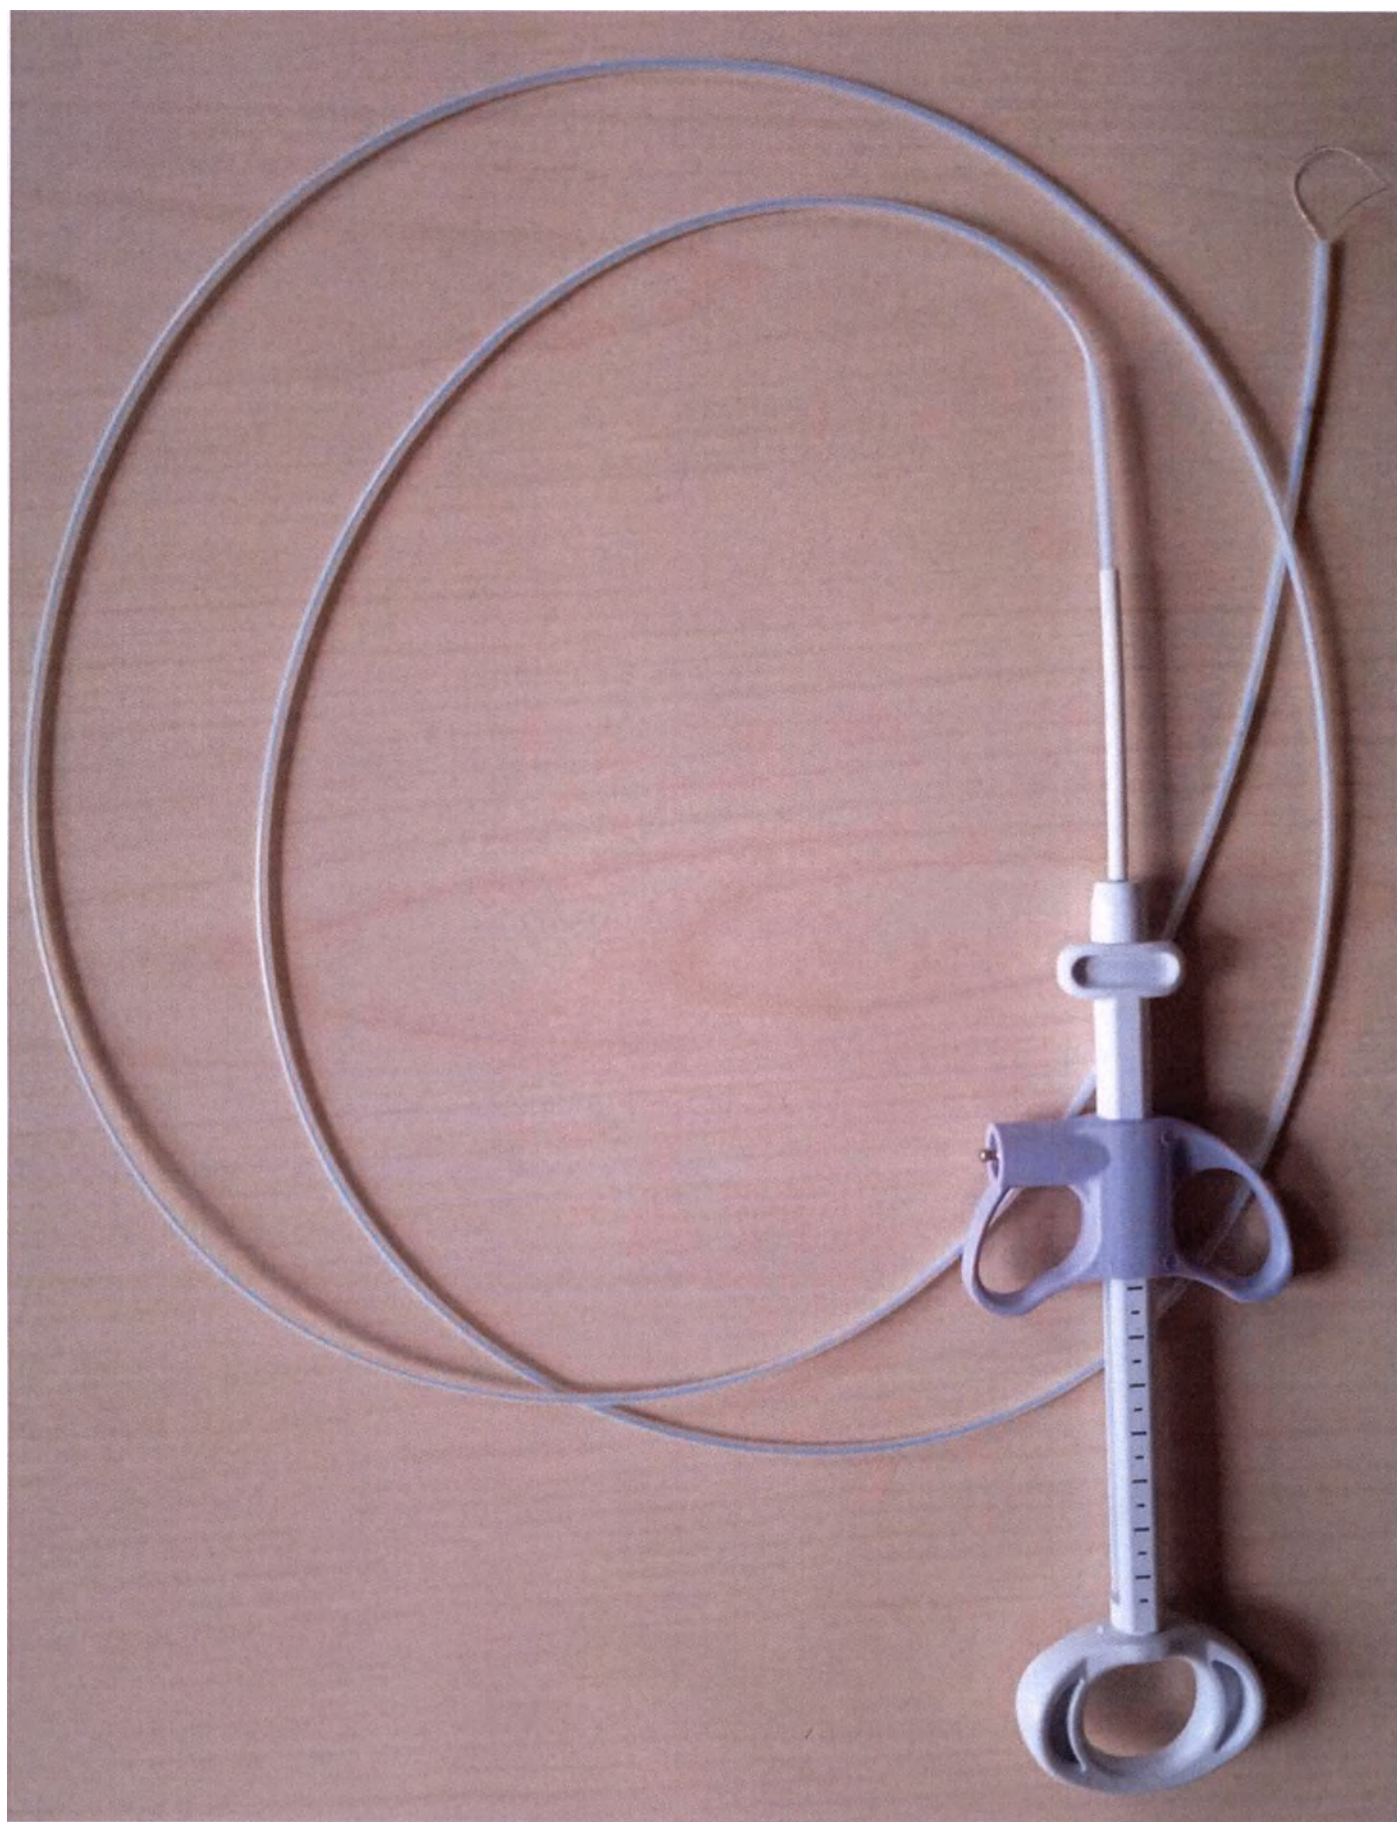

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23DN-25 (в первичной упаковке)



вариант исполнения: KSN23DN-25 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN22HC-10



Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-10 (в первичной упаковке)

2021/6/6 17:01



Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN22HC - 10

2.3mm 10mm
 2200mm

2023-07-05 2020-07-06
LOT 17CSNAJG02G03

STERILE

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN22HC - 10 17CSNAJG02G03


Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN22HC - 10 17CSNAJG02G03

8 889234 337492

TaeWoong
 MEDICAL
 1817-32 (Rev. 08) 2020.01.10

GS1-128 (UCC / EAN-128)
 8 170805 343374 92 (11) 200706 (17) 200705 (21) 17CSNAJG02G03

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-10 (во вторичной упаковке)

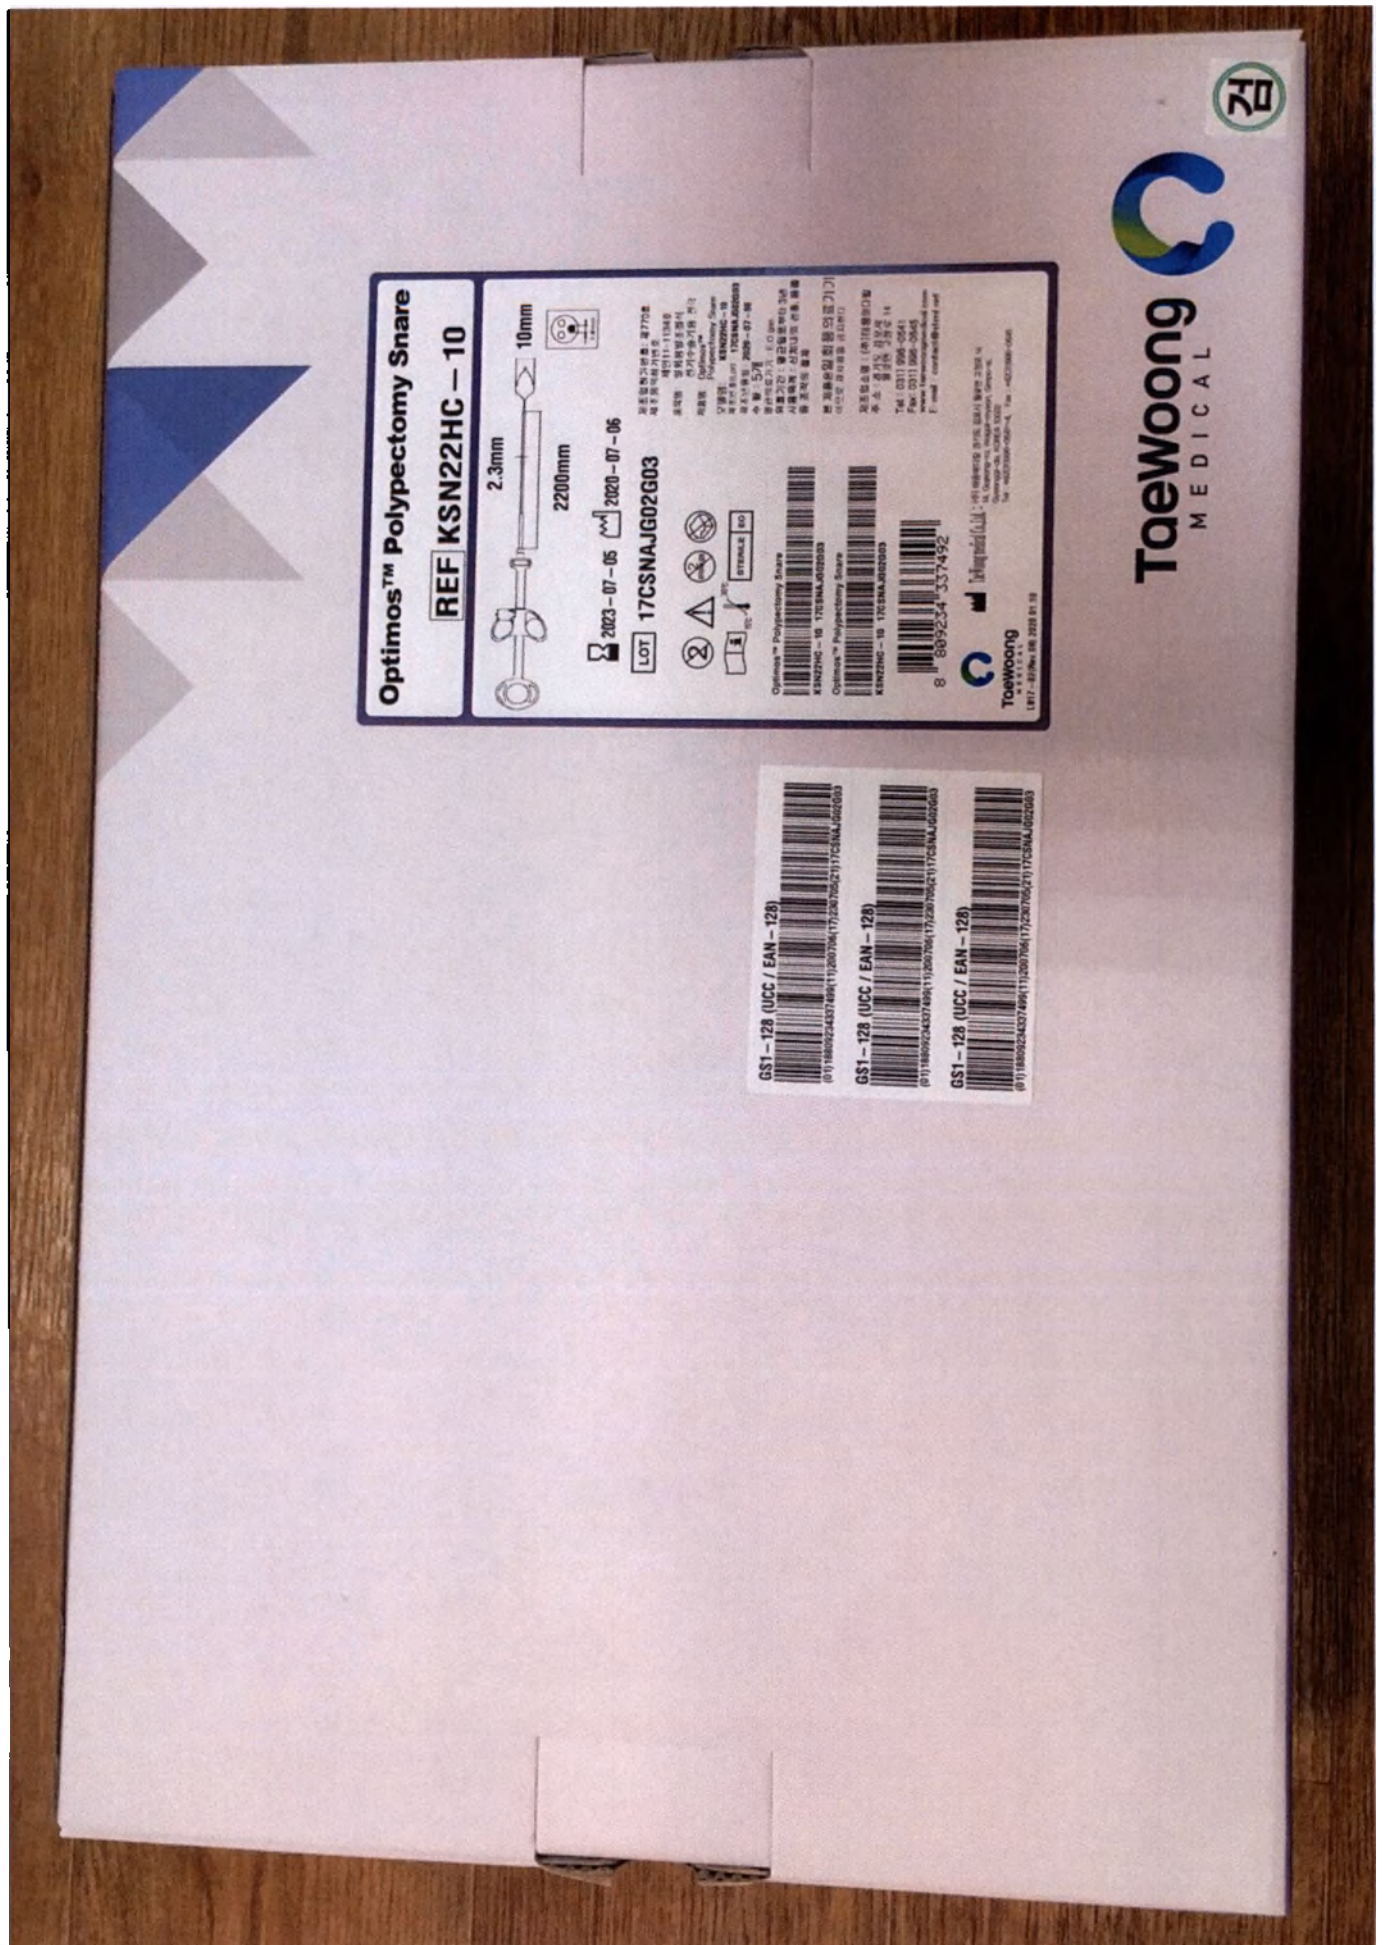

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-15




2021/6/6 17:08

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-15 (в первичной упаковке)



2021/6/6 17:07

Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-15 (во вторичной упаковке)

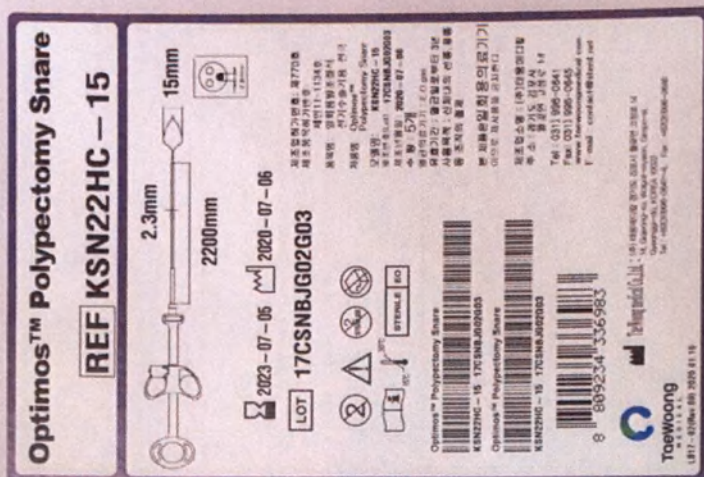

TaeWoong
MEDICAL

**Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN22HC-20**





Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-20 (в первичной упаковке)

2021/6/6 17:12




Петля Optimos для полипэктомии, не вращающаяся, тип «холодная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN22HC-20 (во вторичной упаковке)

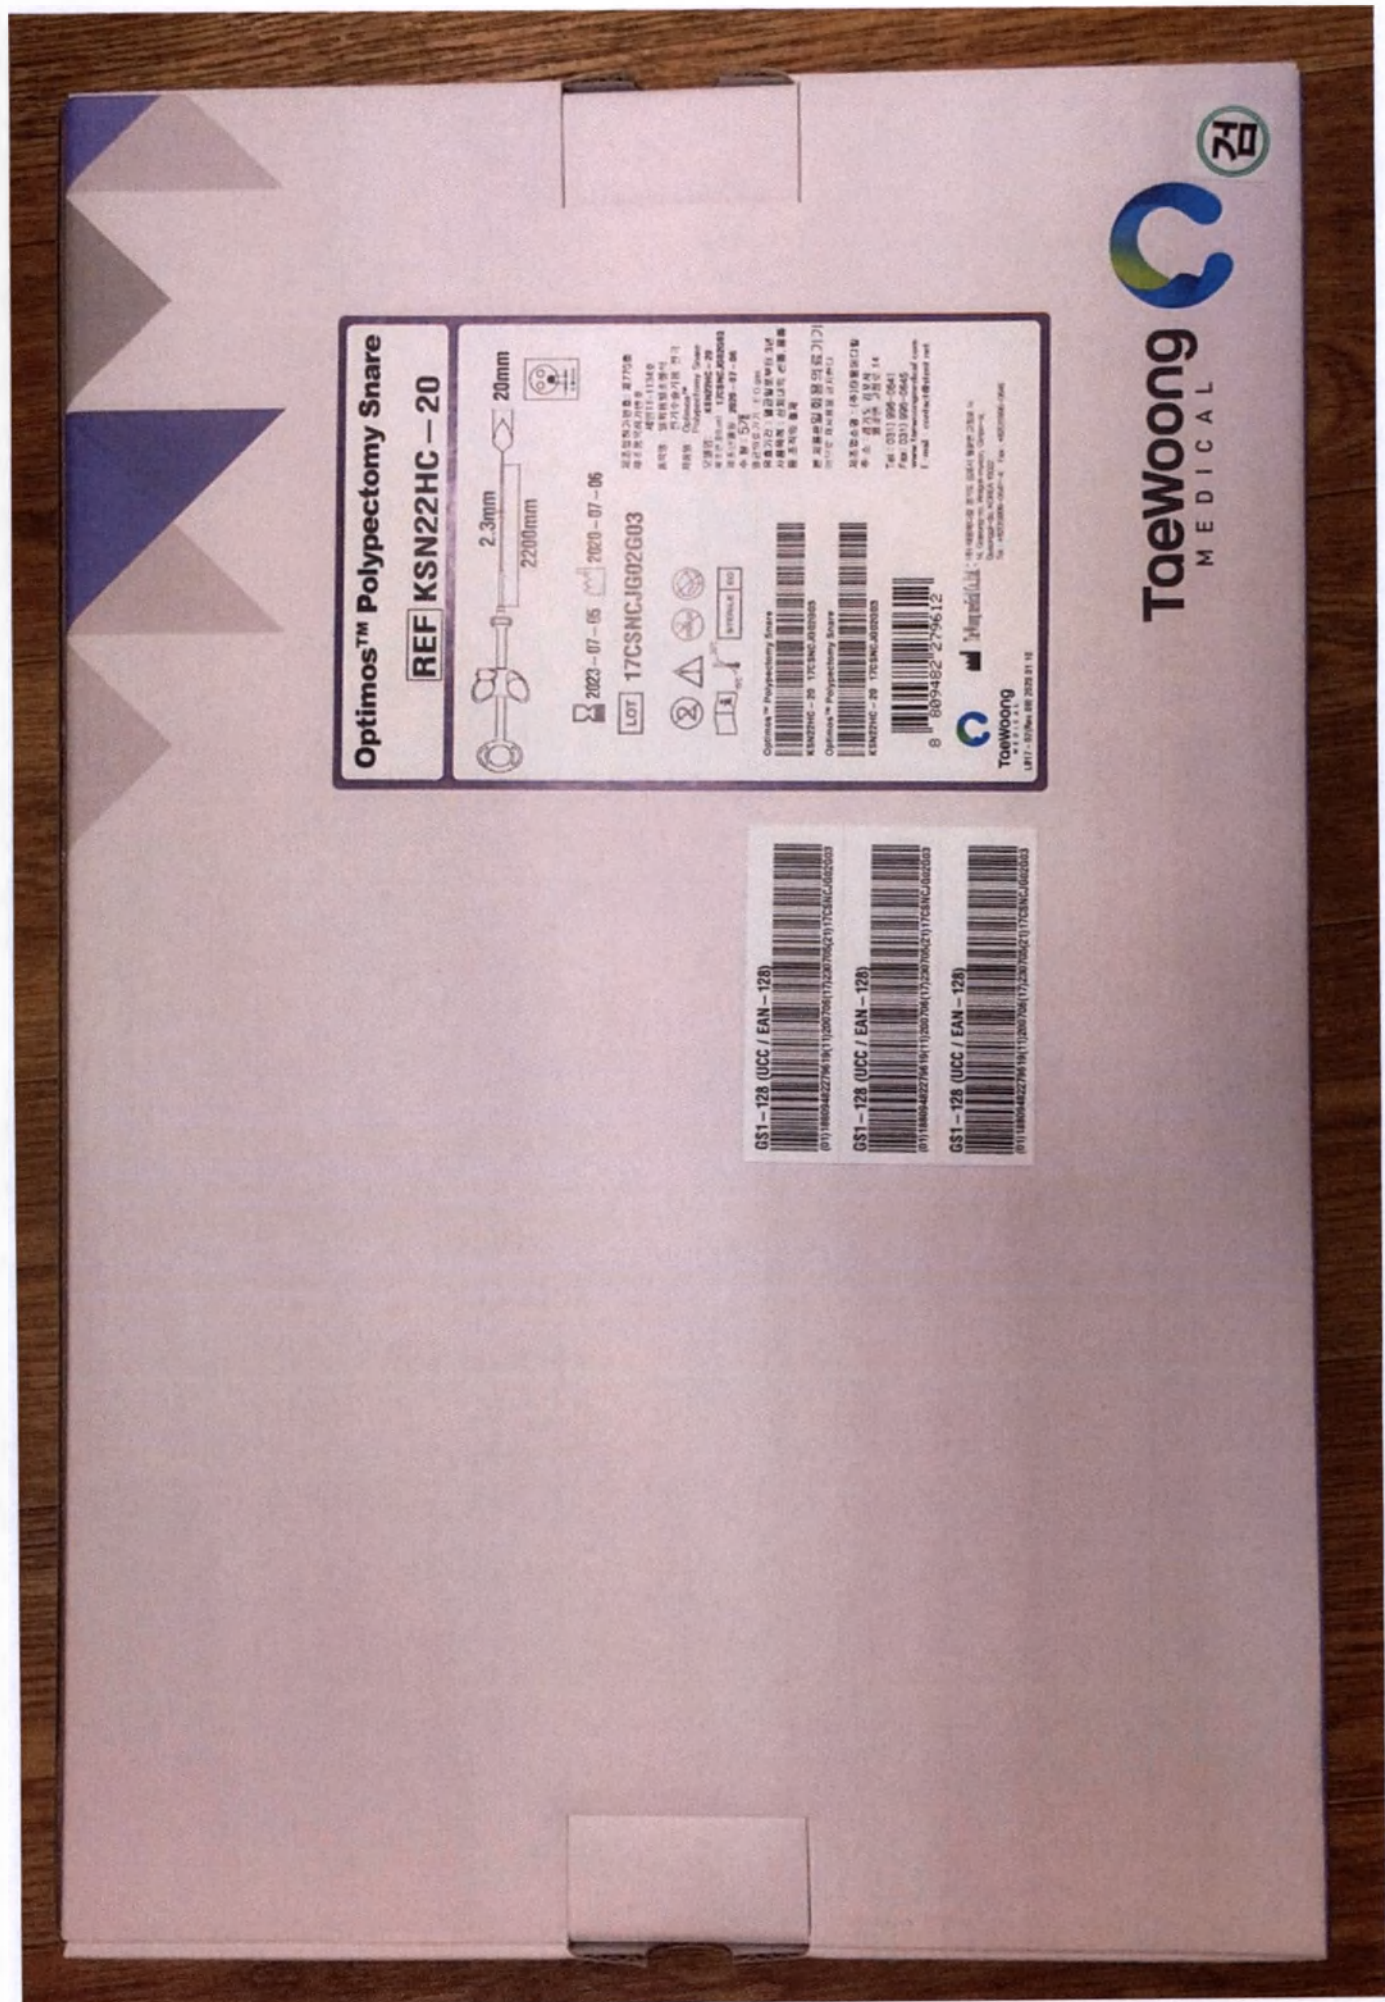

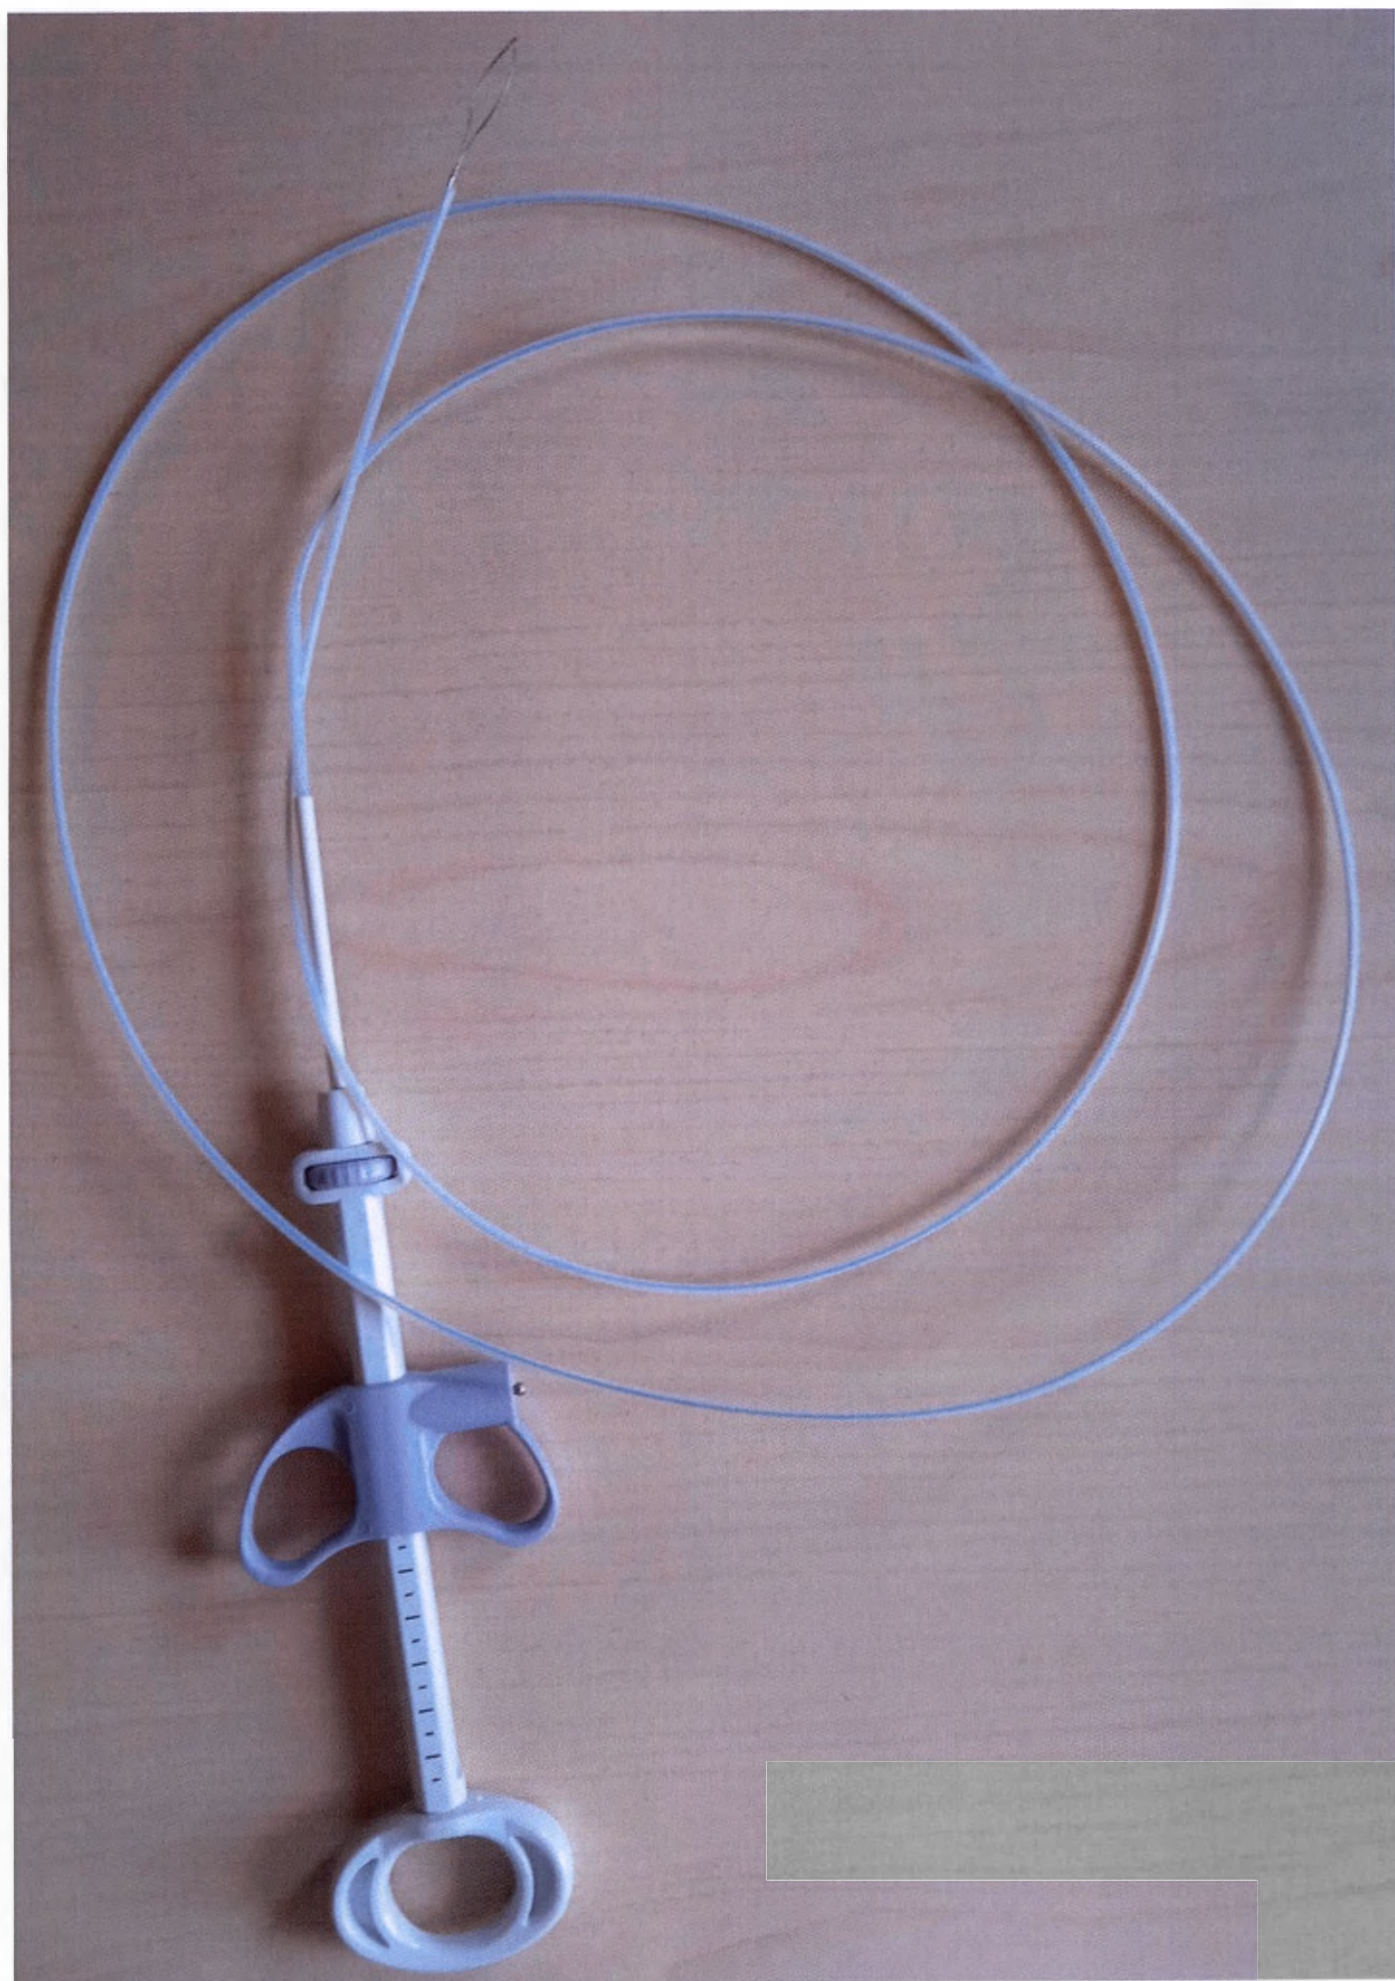

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-10 (в первичной упаковке)



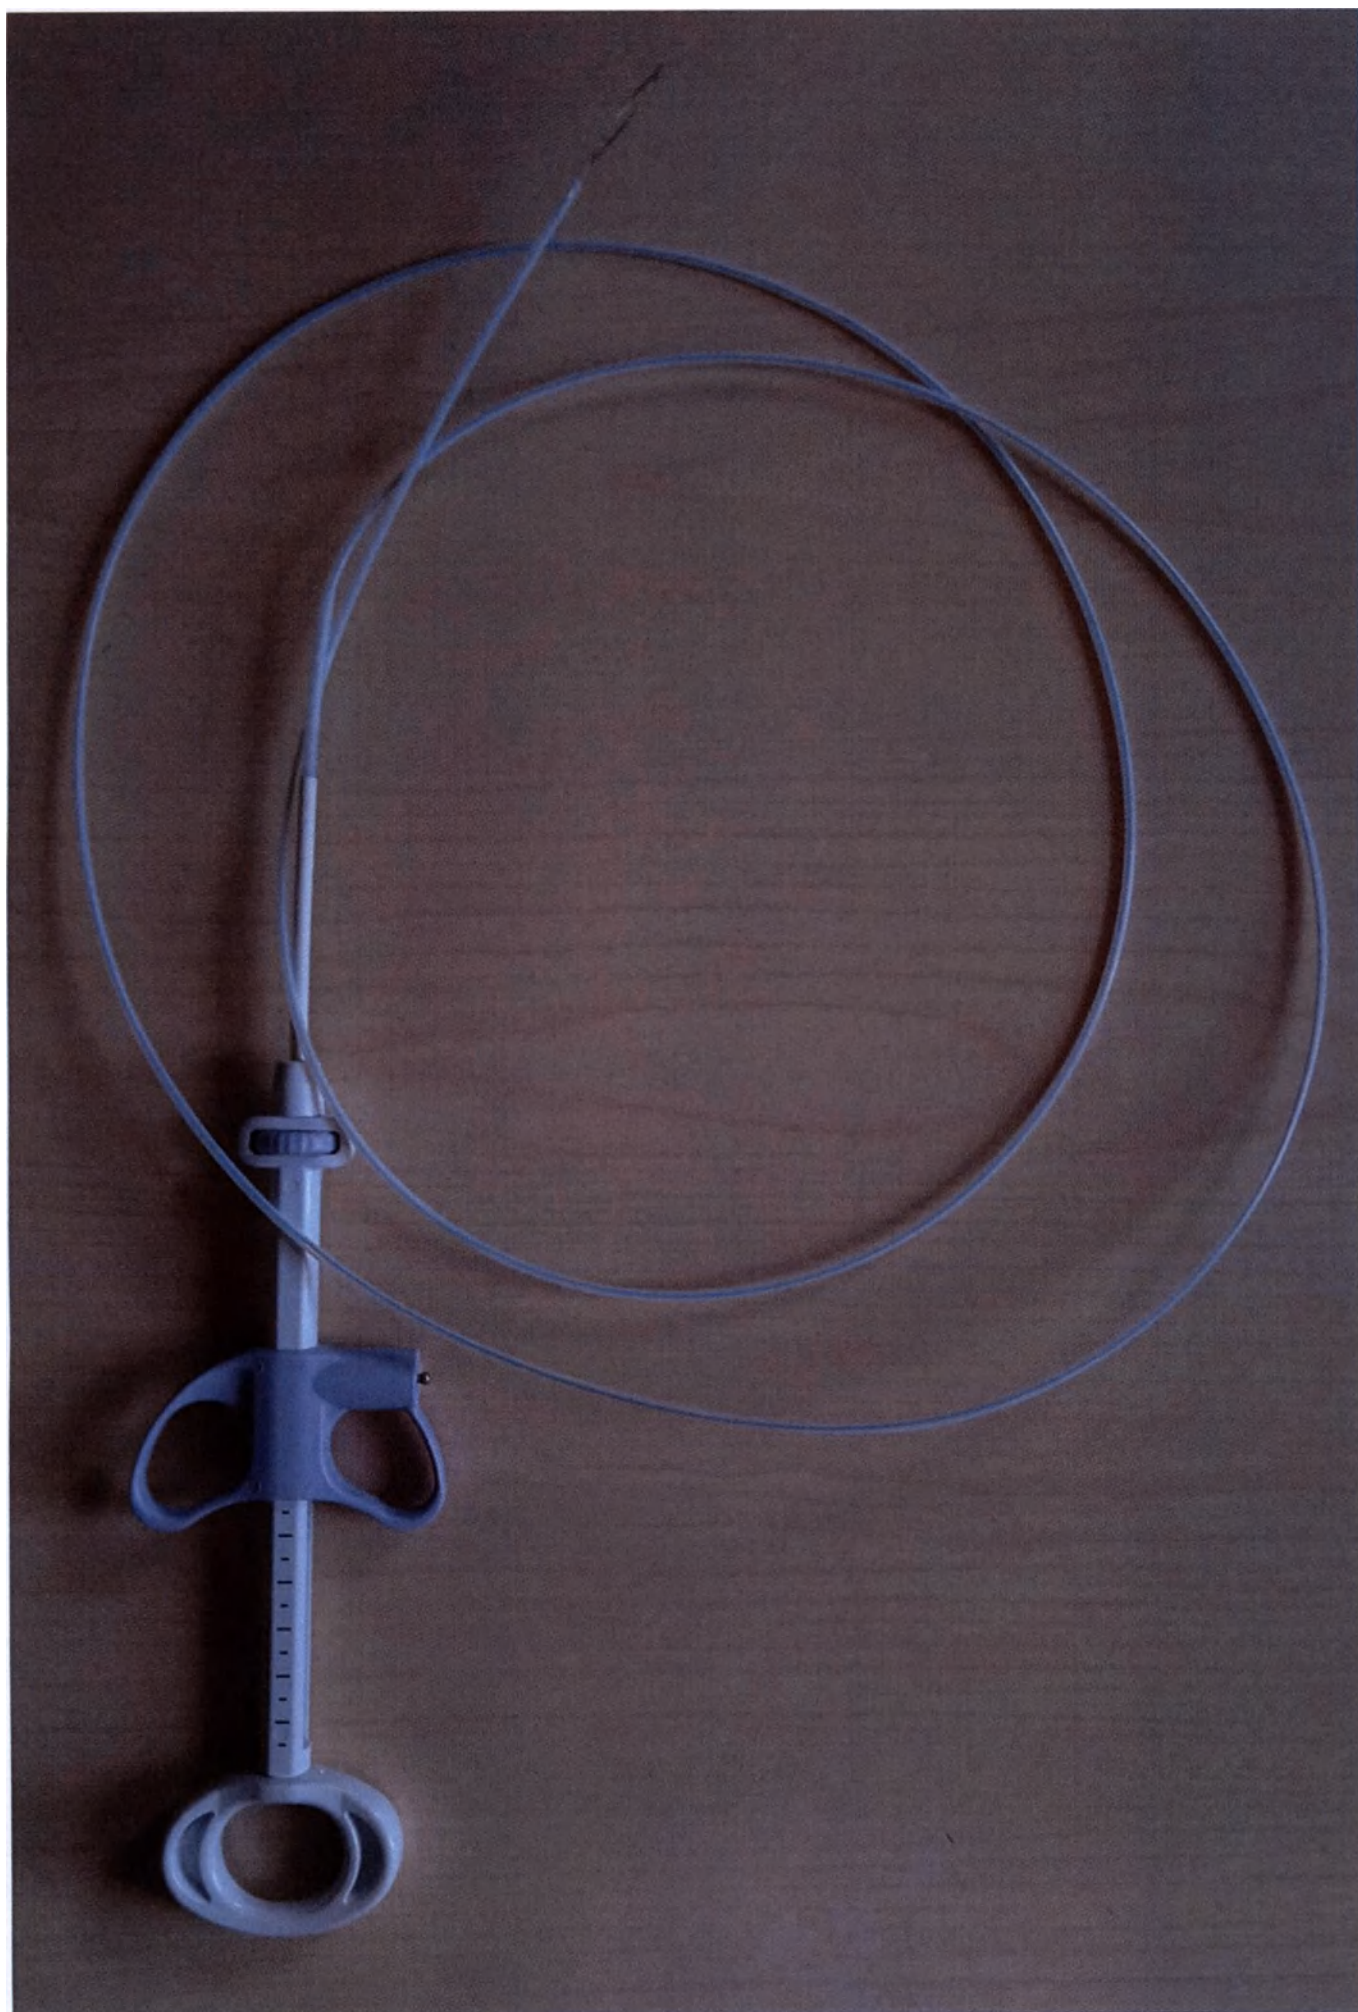


Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-10 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-10 (во вторичной упаковке)




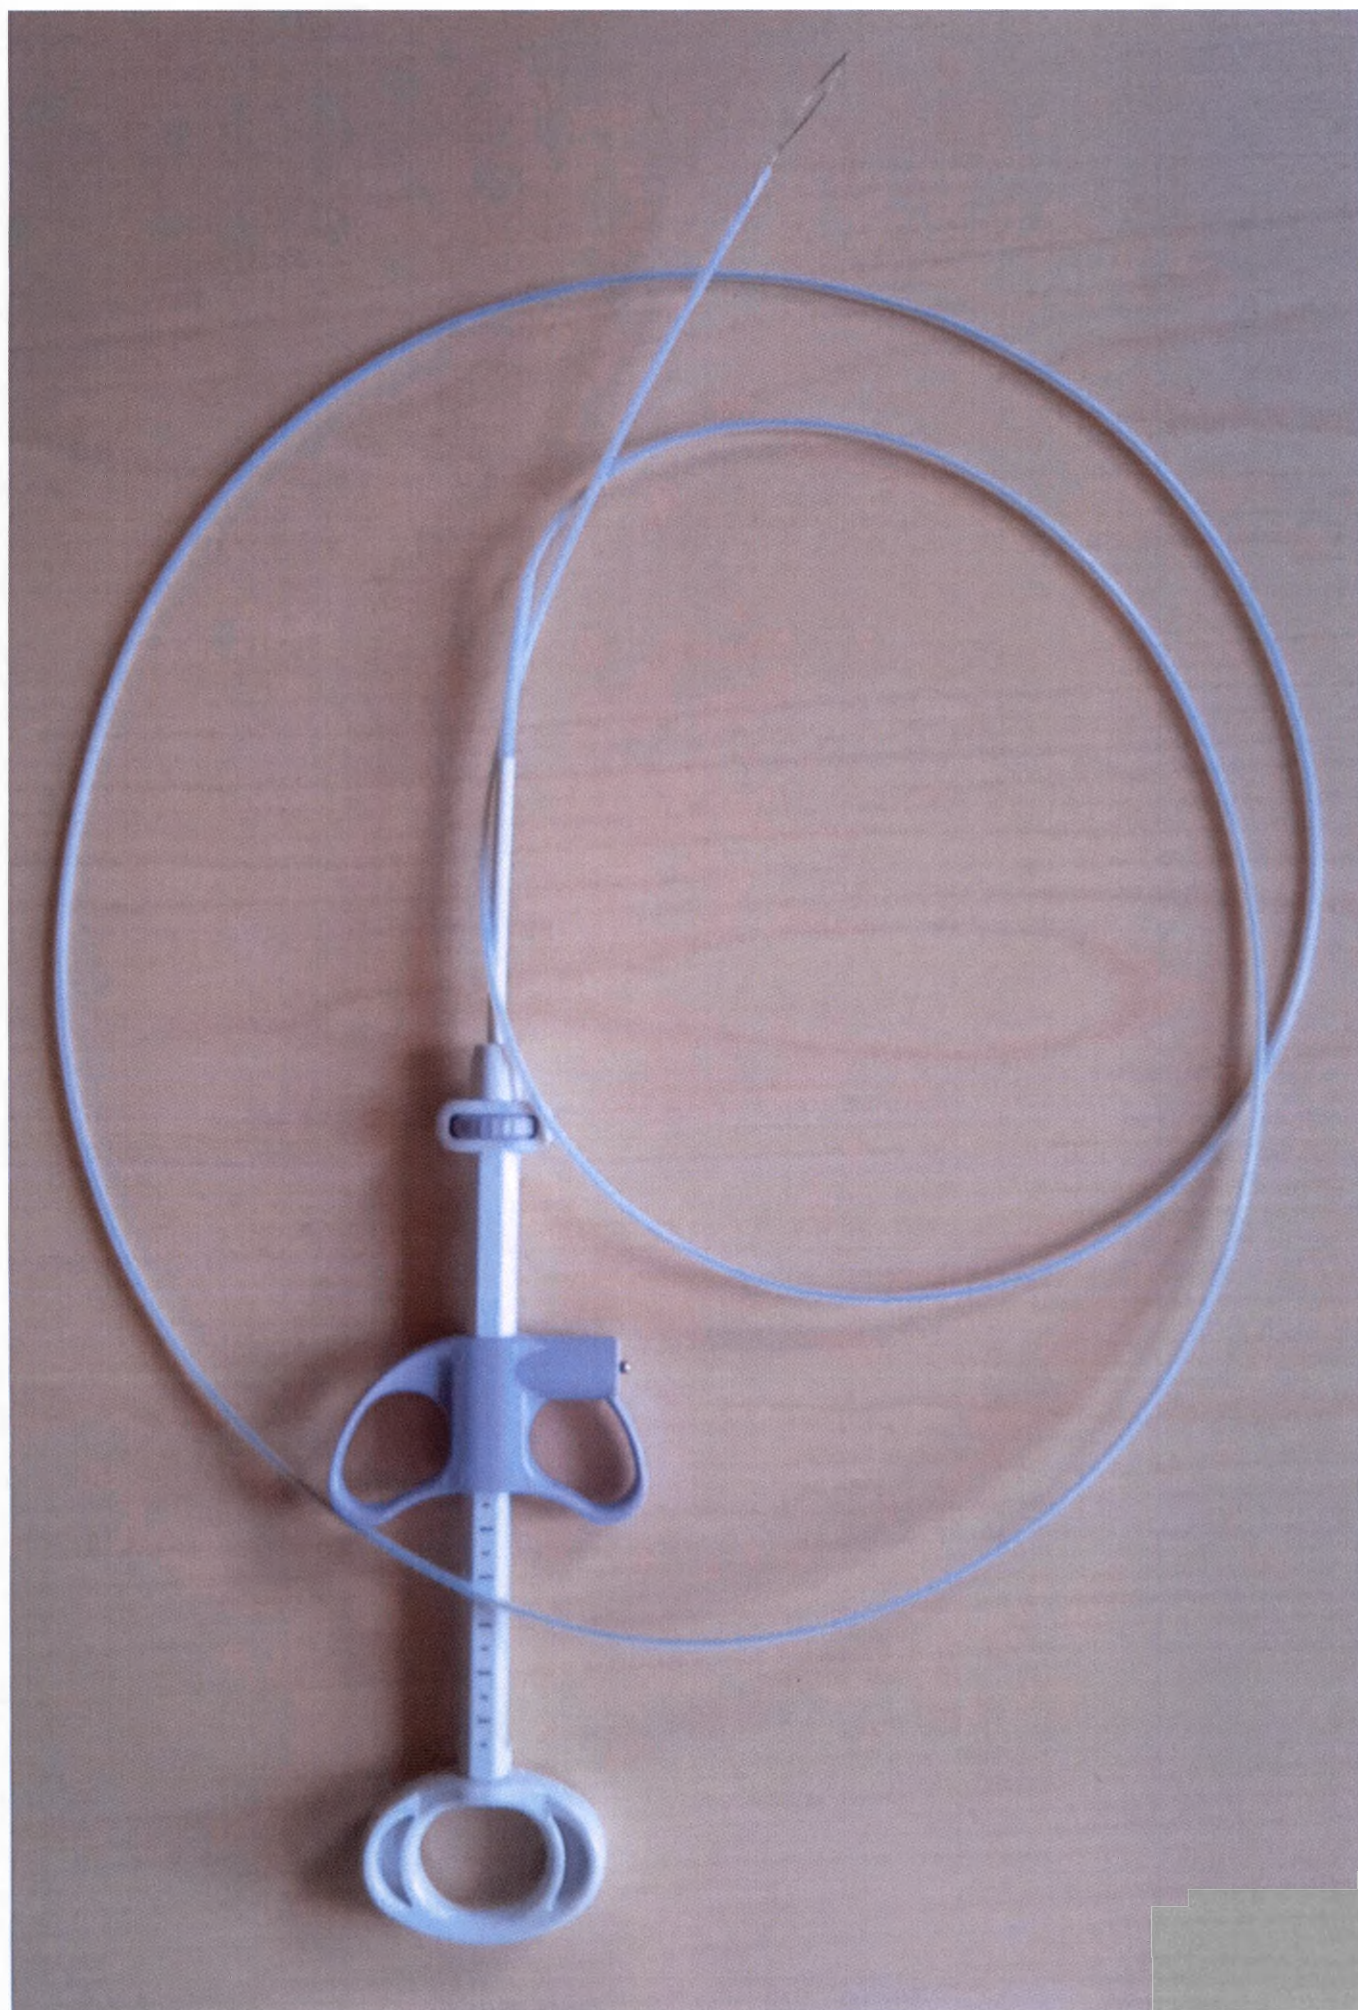

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-15 (в первичной упаковке)



2021/6/20 17:41

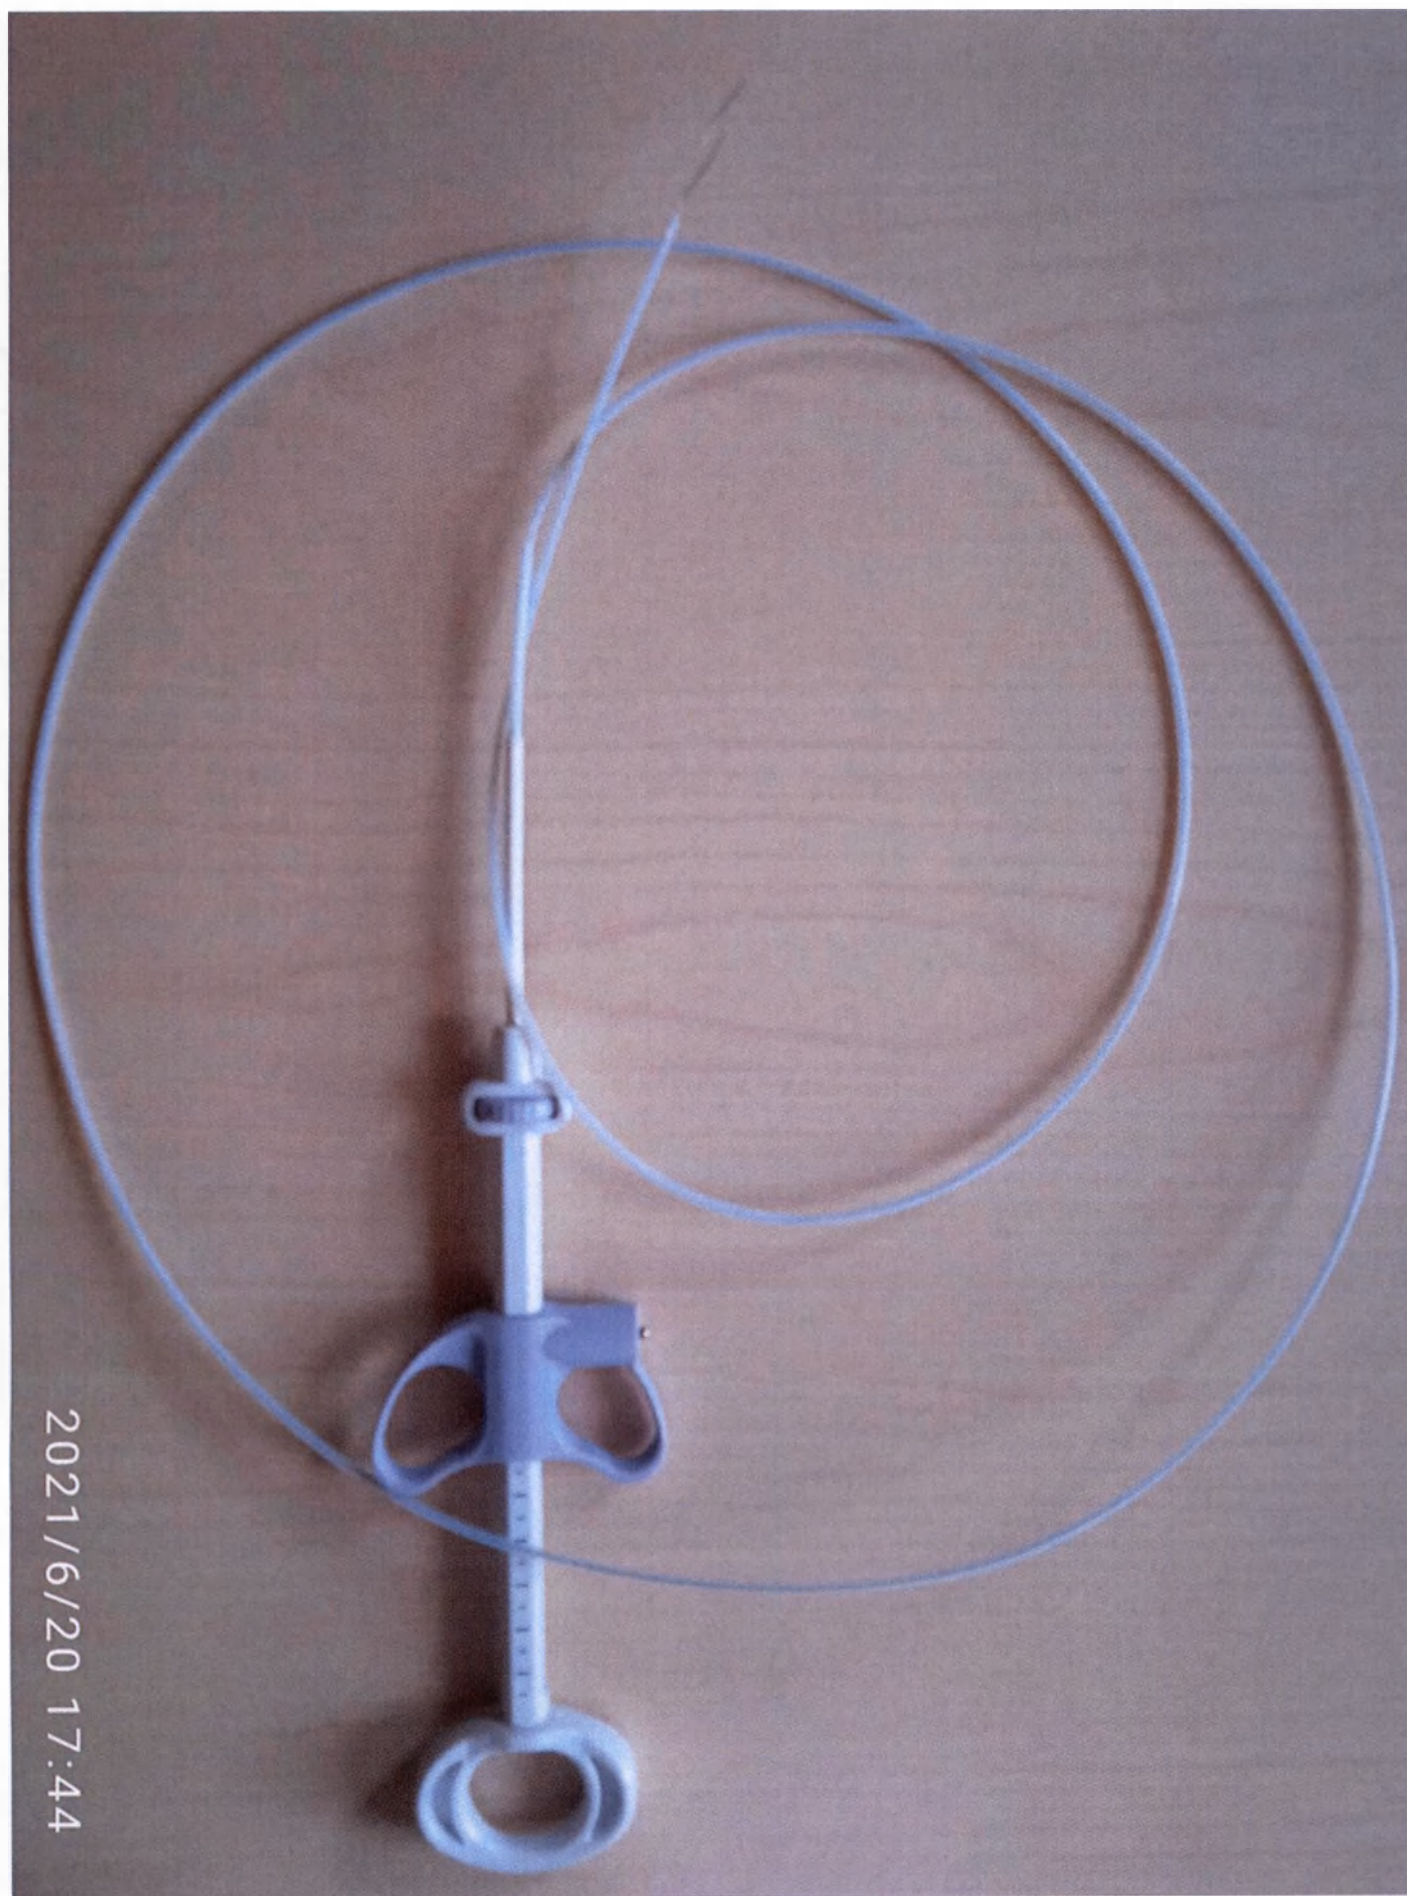

2021/6/20 17:44


Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-15 (в первичной упаковке)



2021/6/20 17:4

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-15 (во вторичной упаковке)



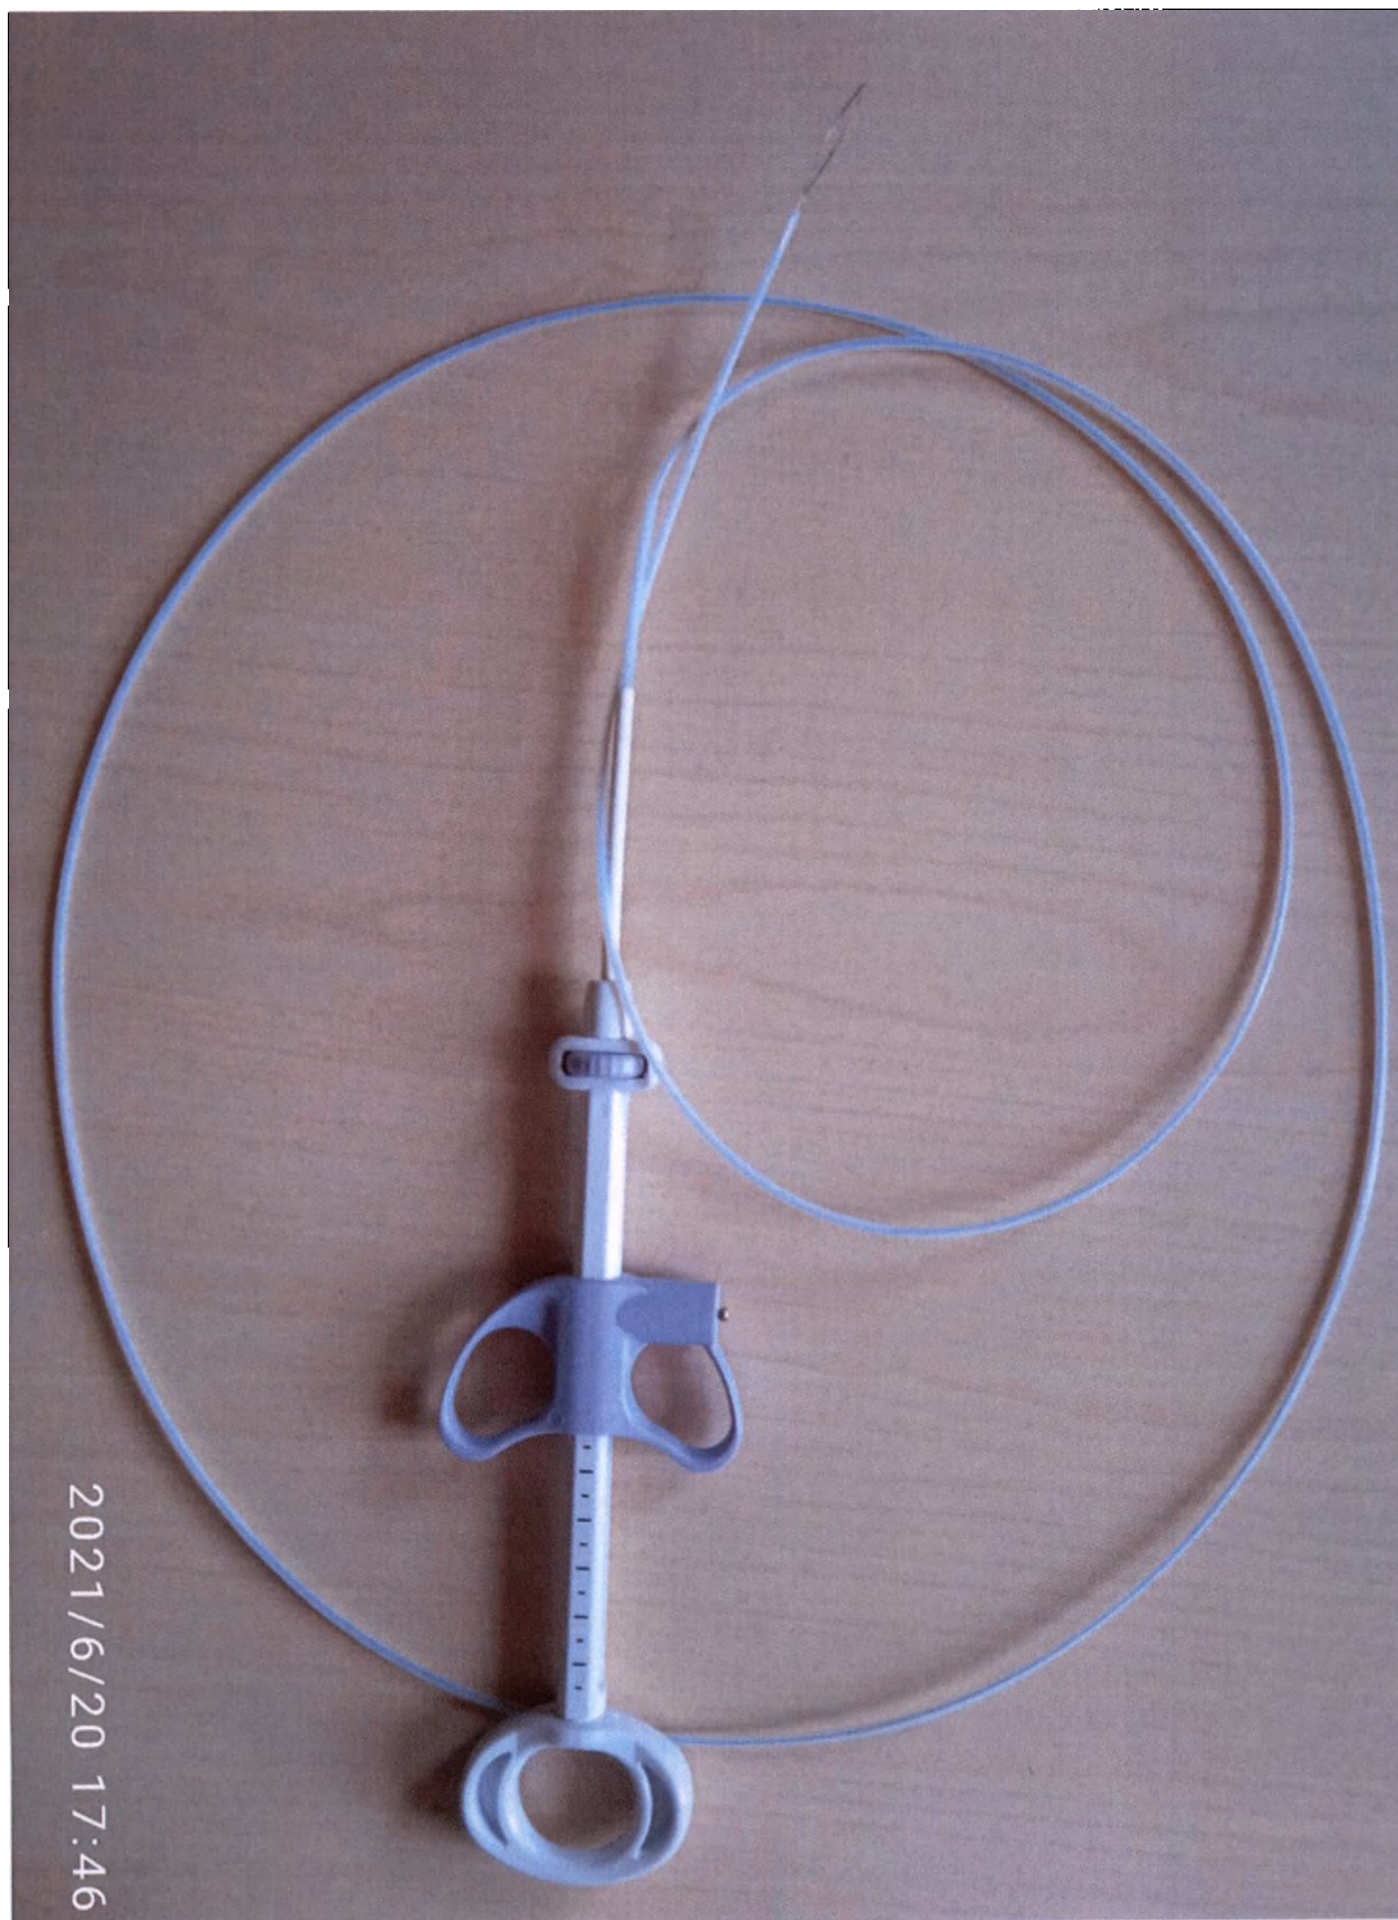



2021/6/20 17:46

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-20 (в первичной упаковке)




2021/6/20 17:46

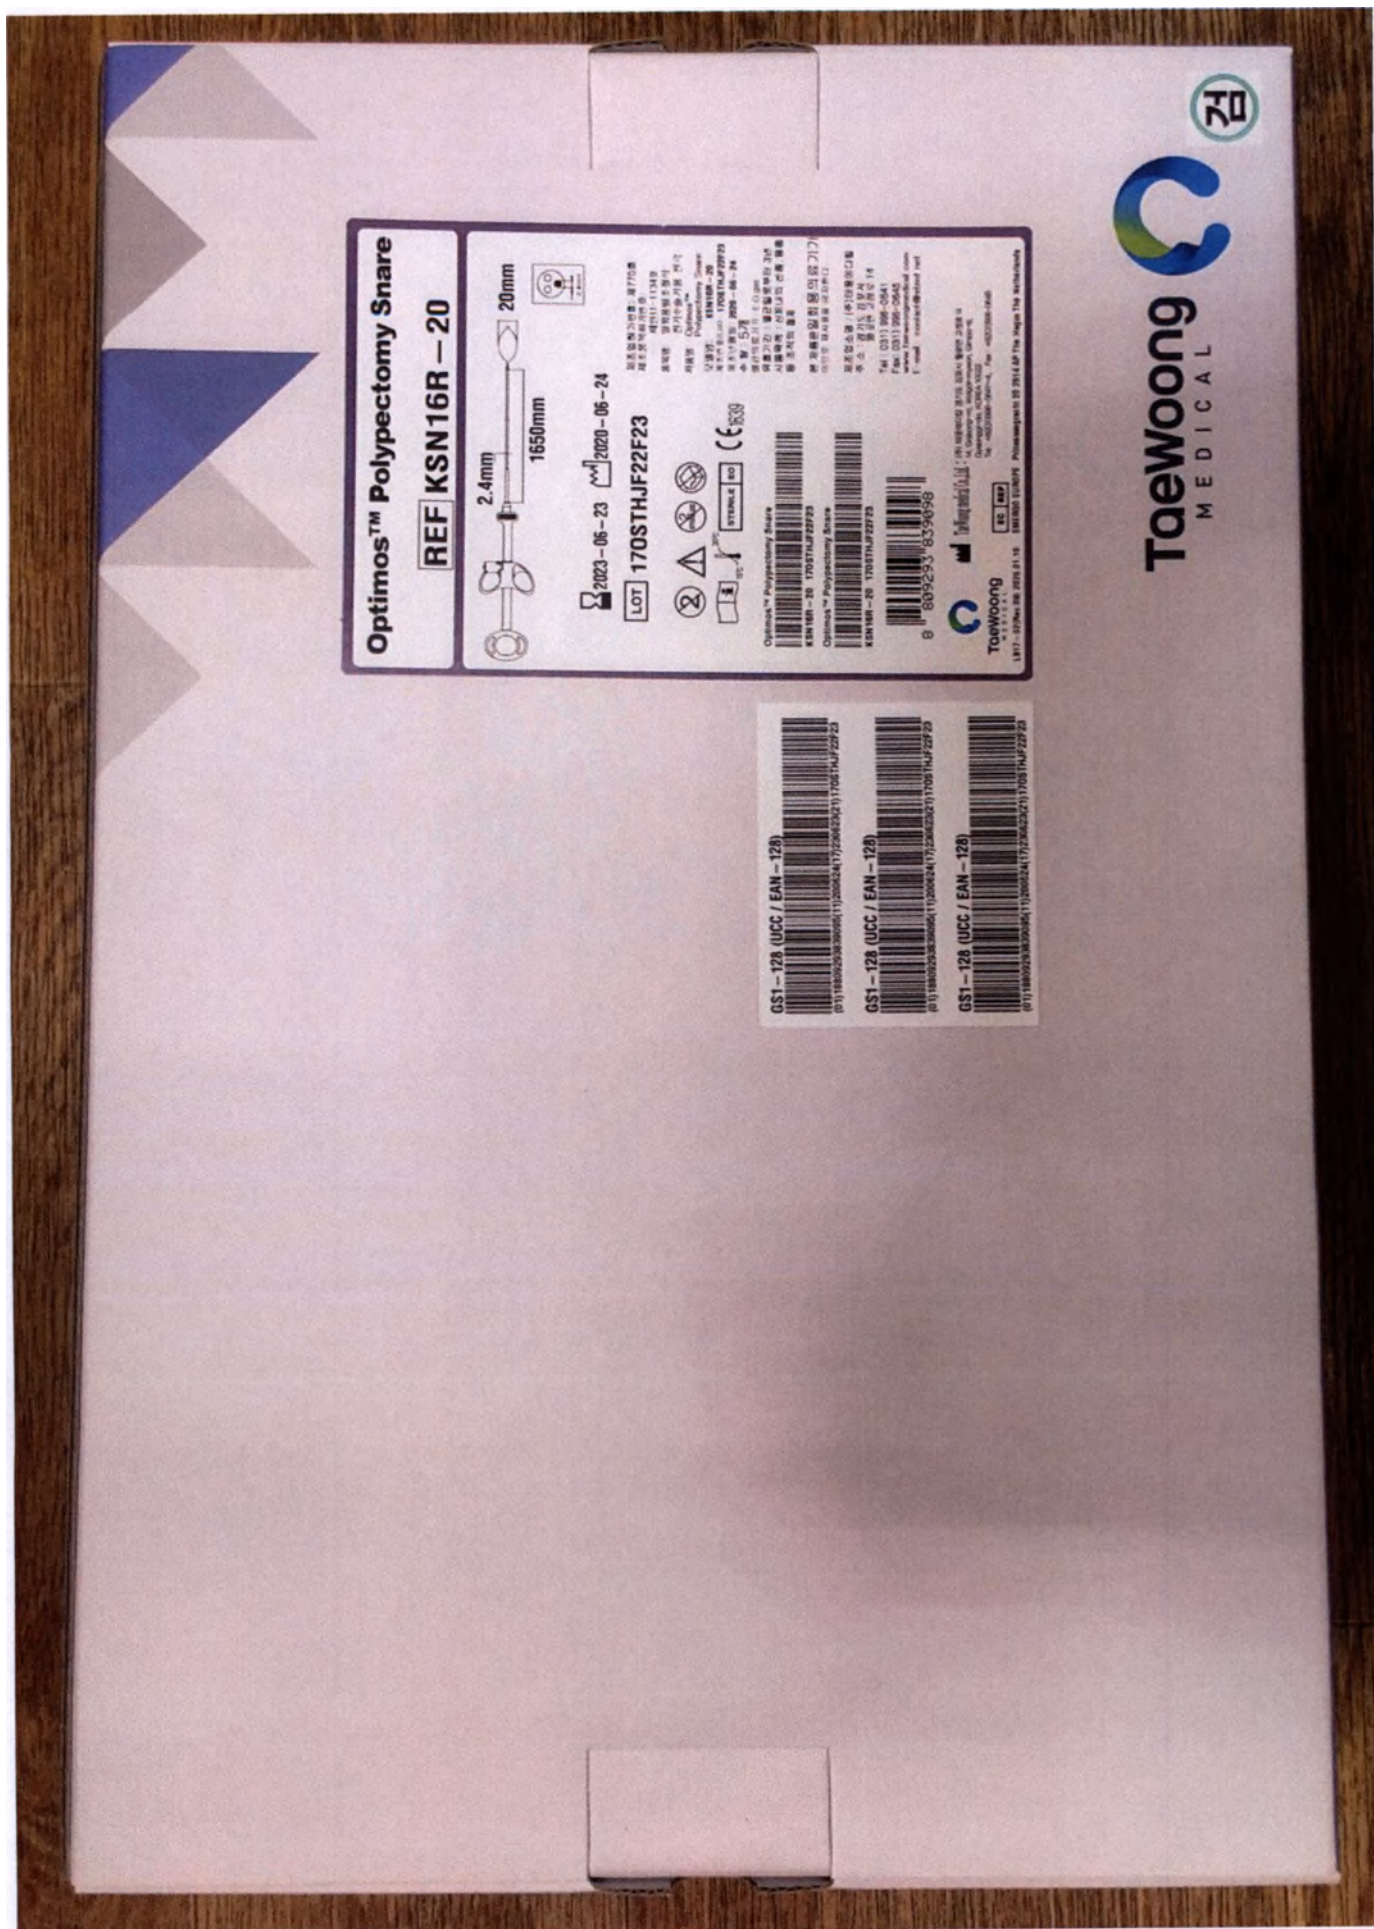

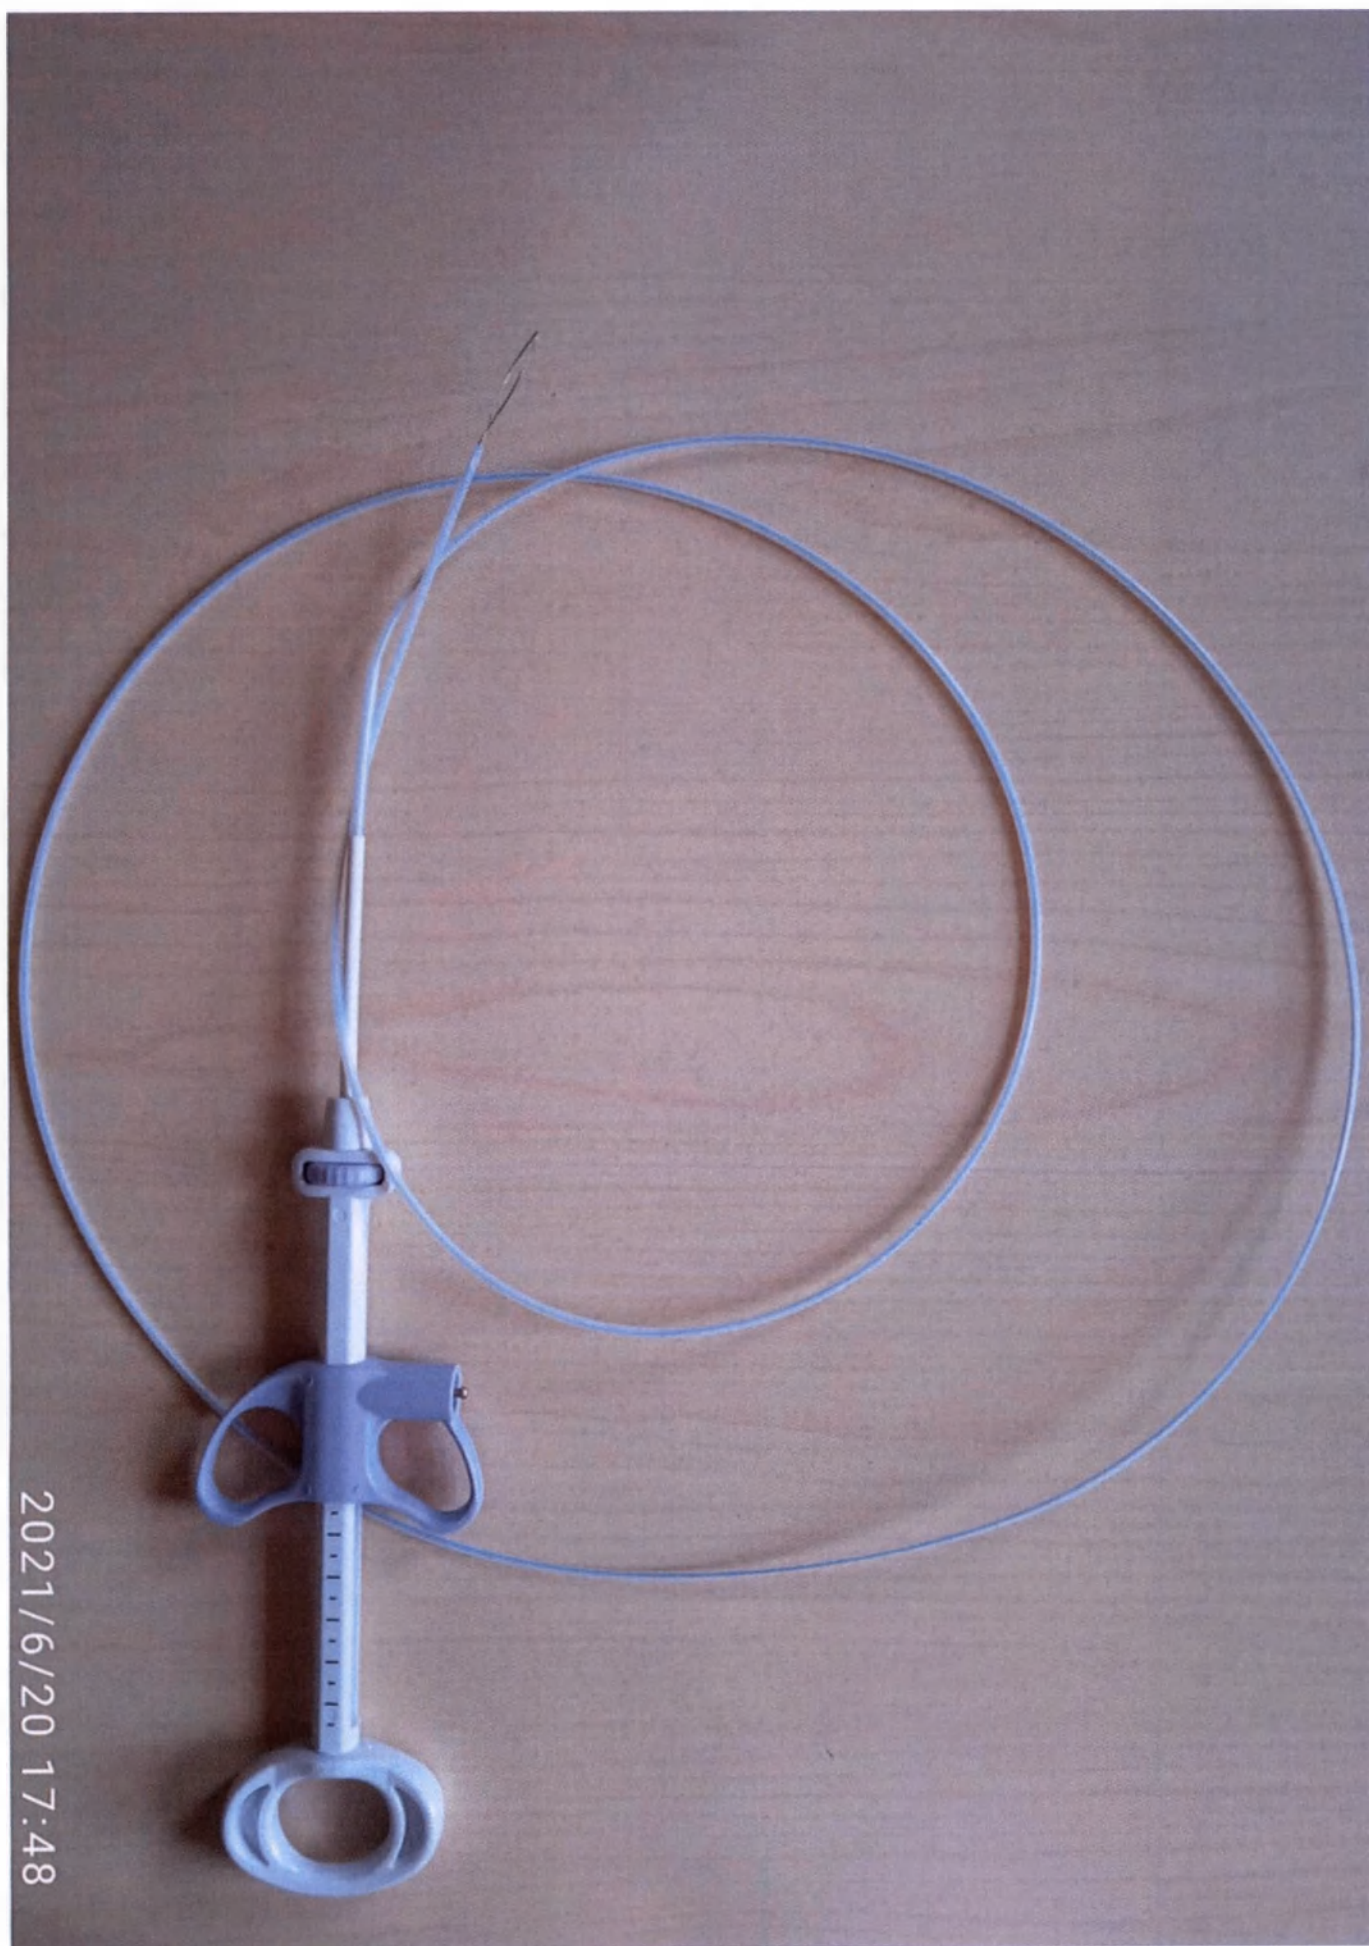



2021/6/20 17:48

2021/6/20 17:48

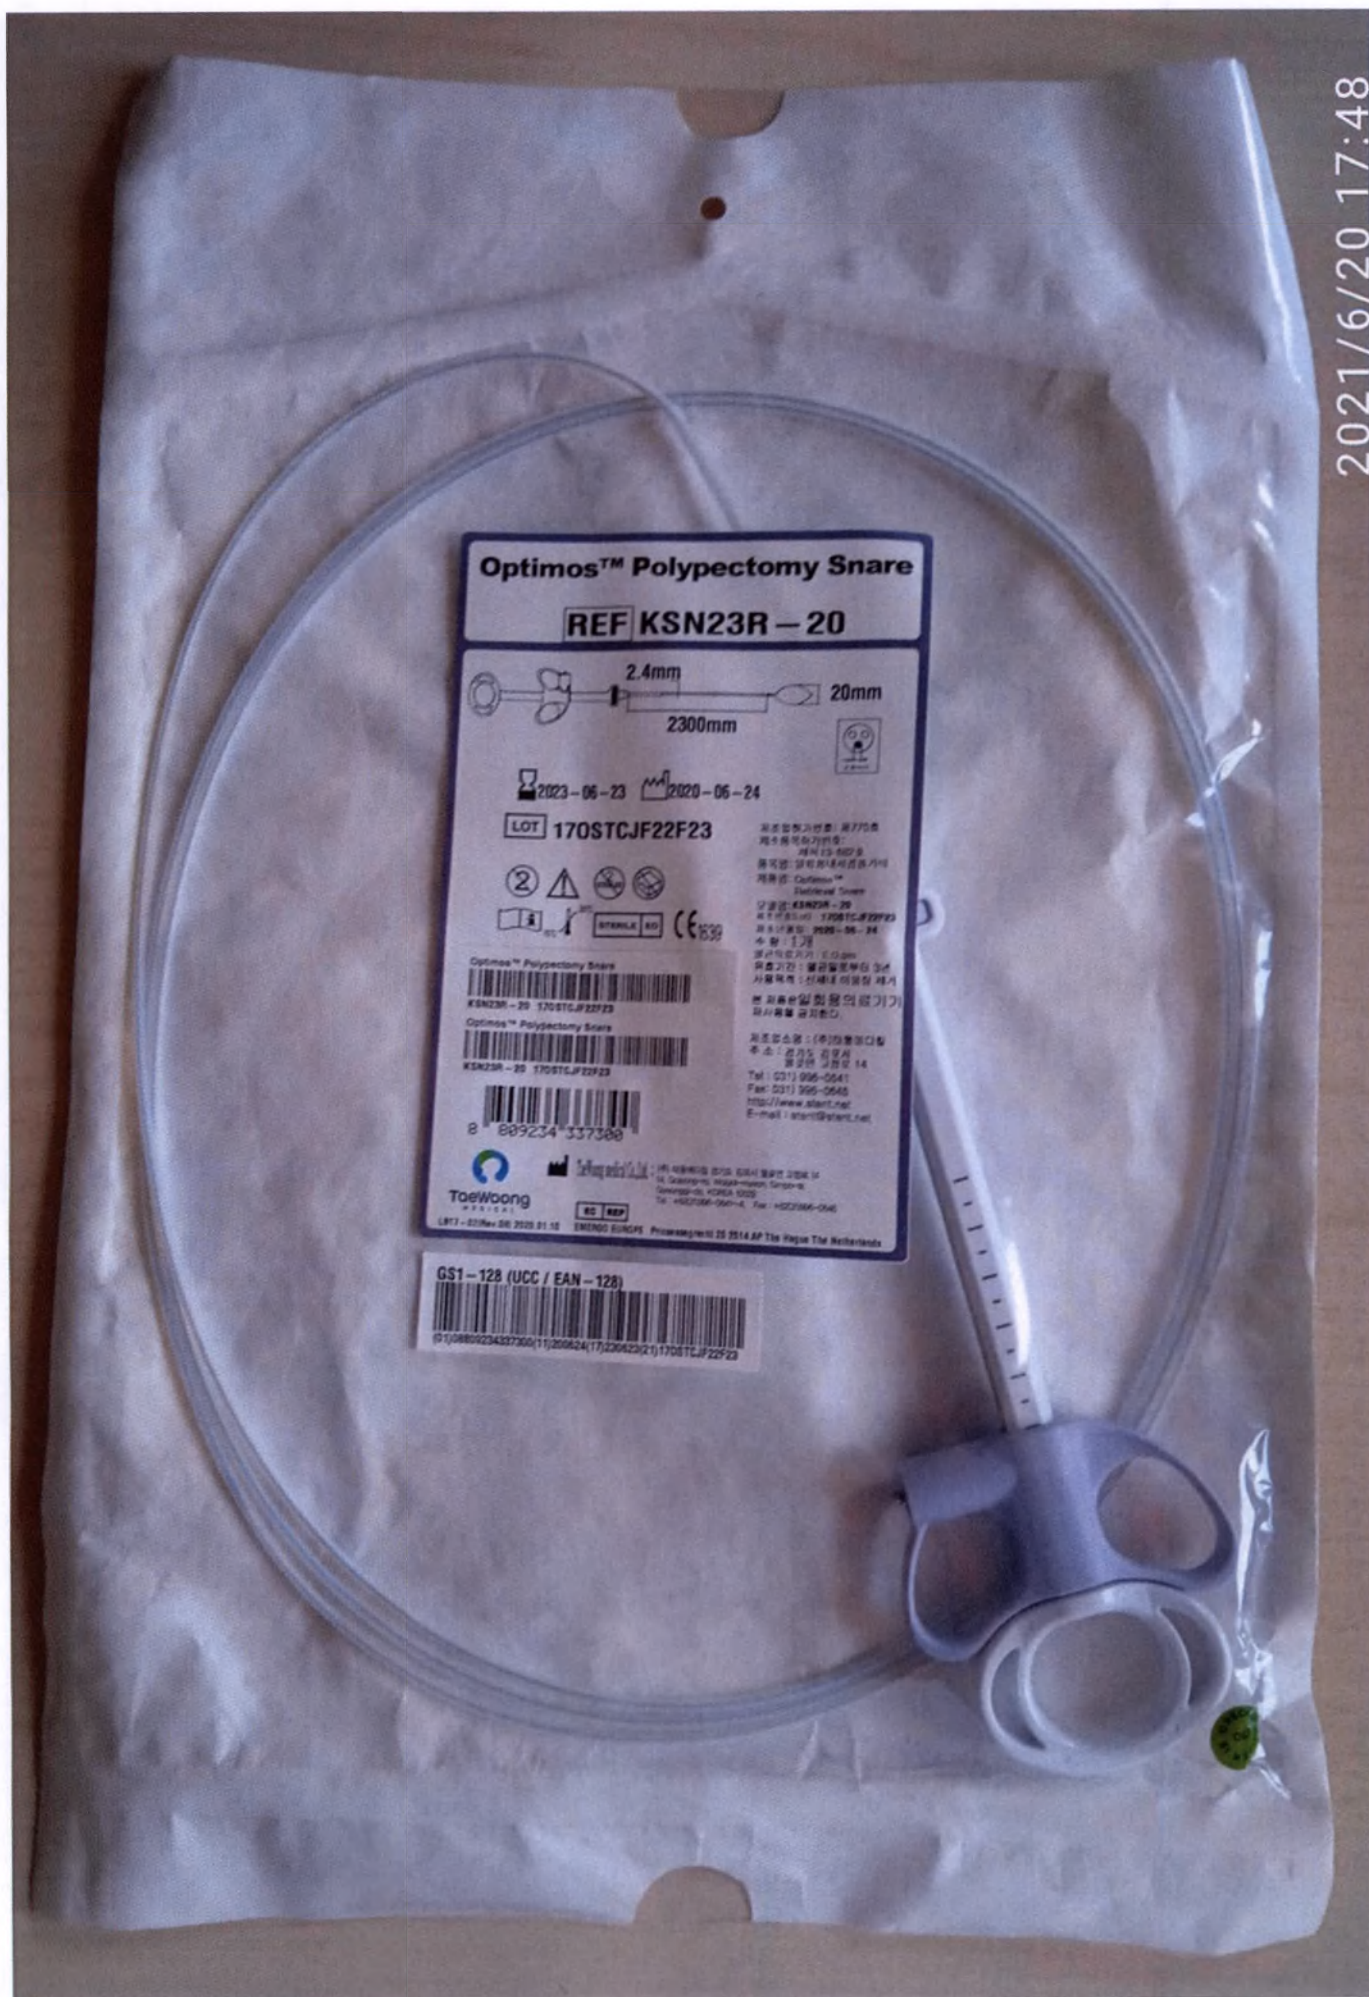

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-20 (во вторичной упаковке)

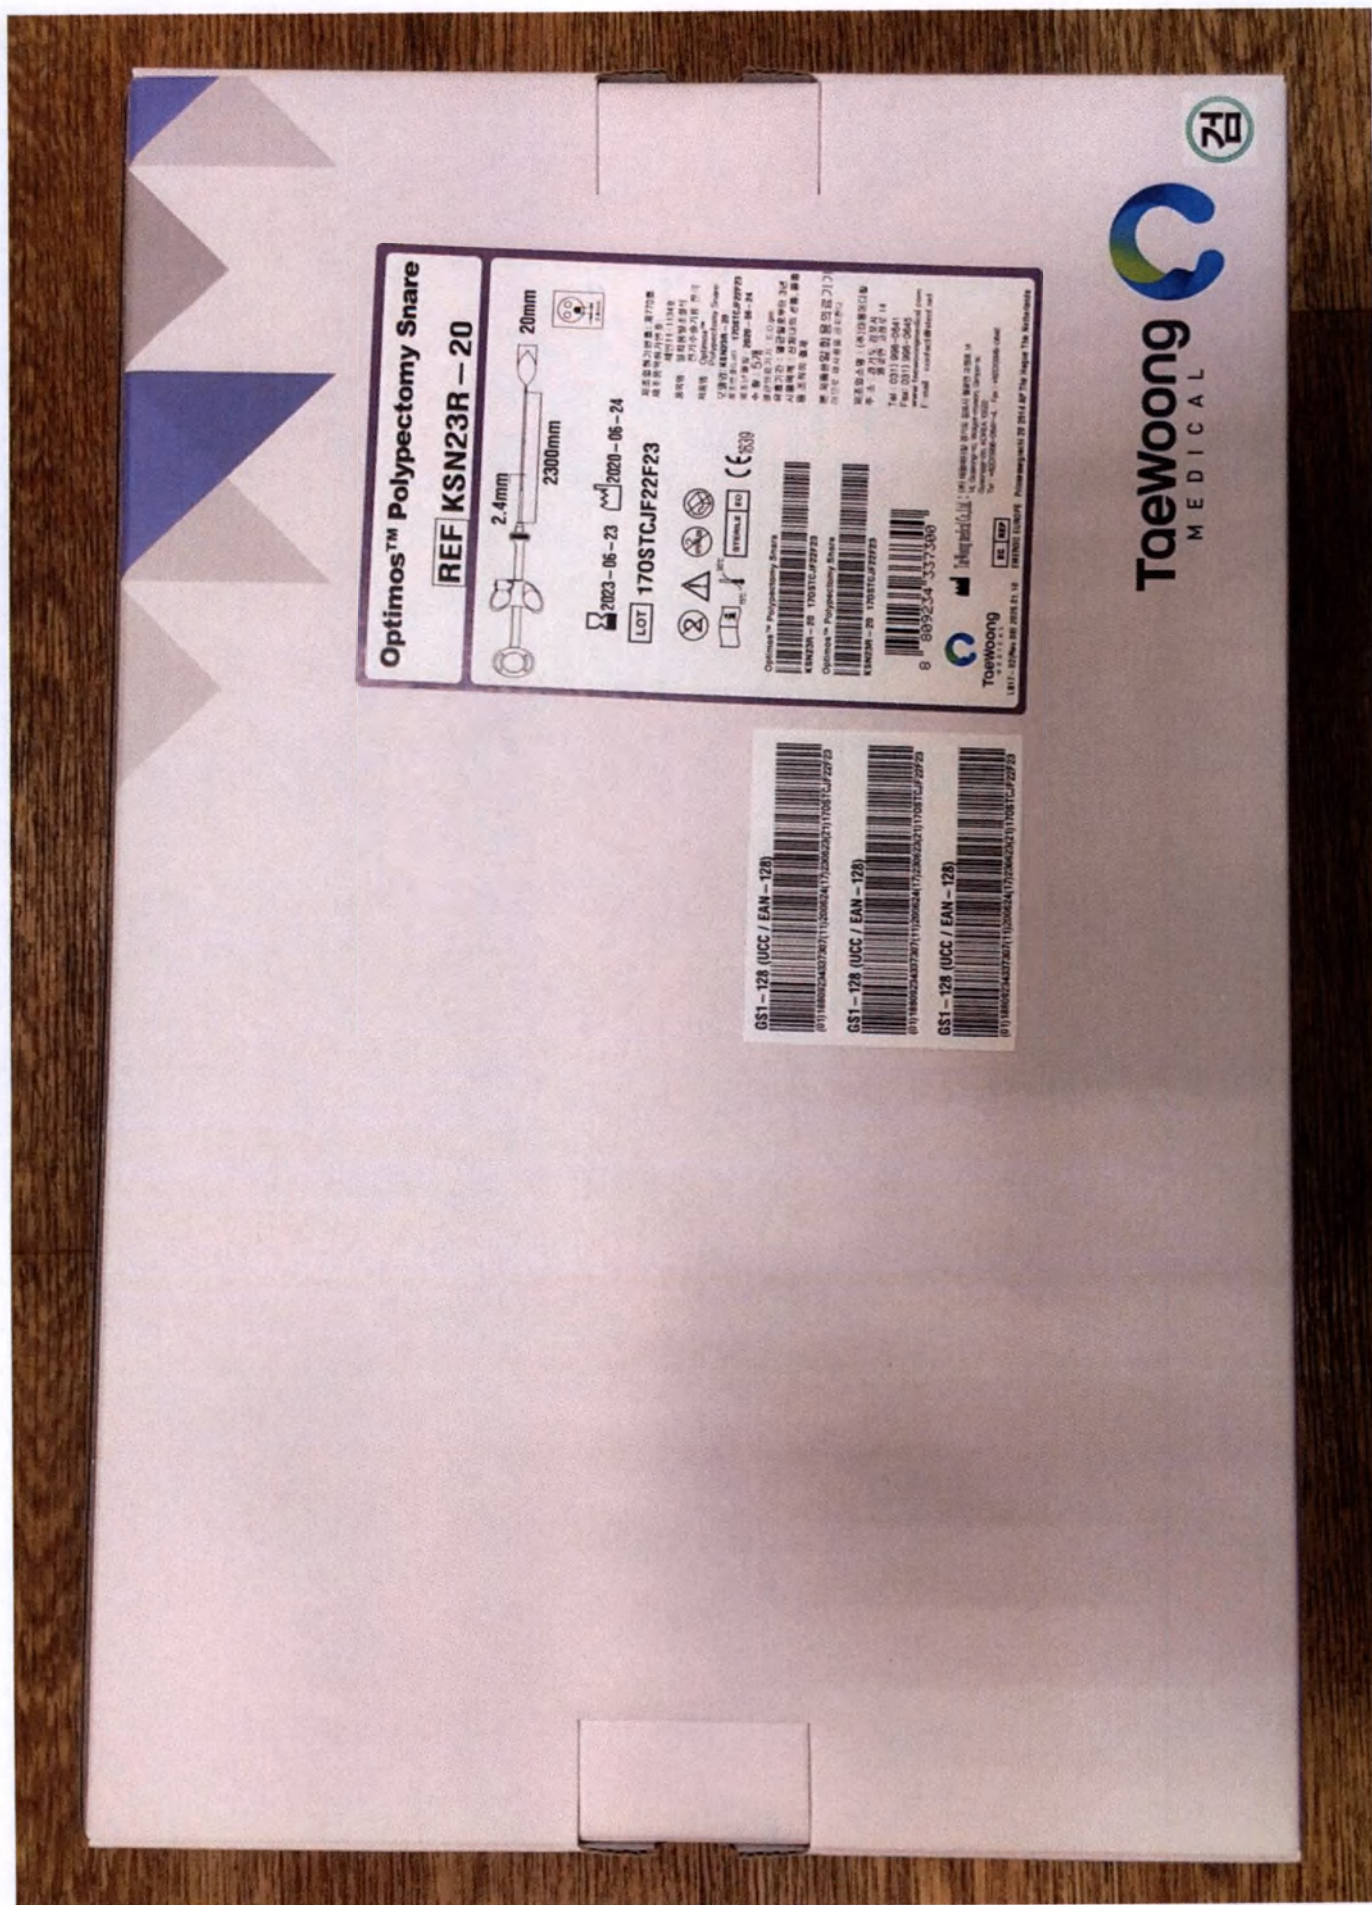


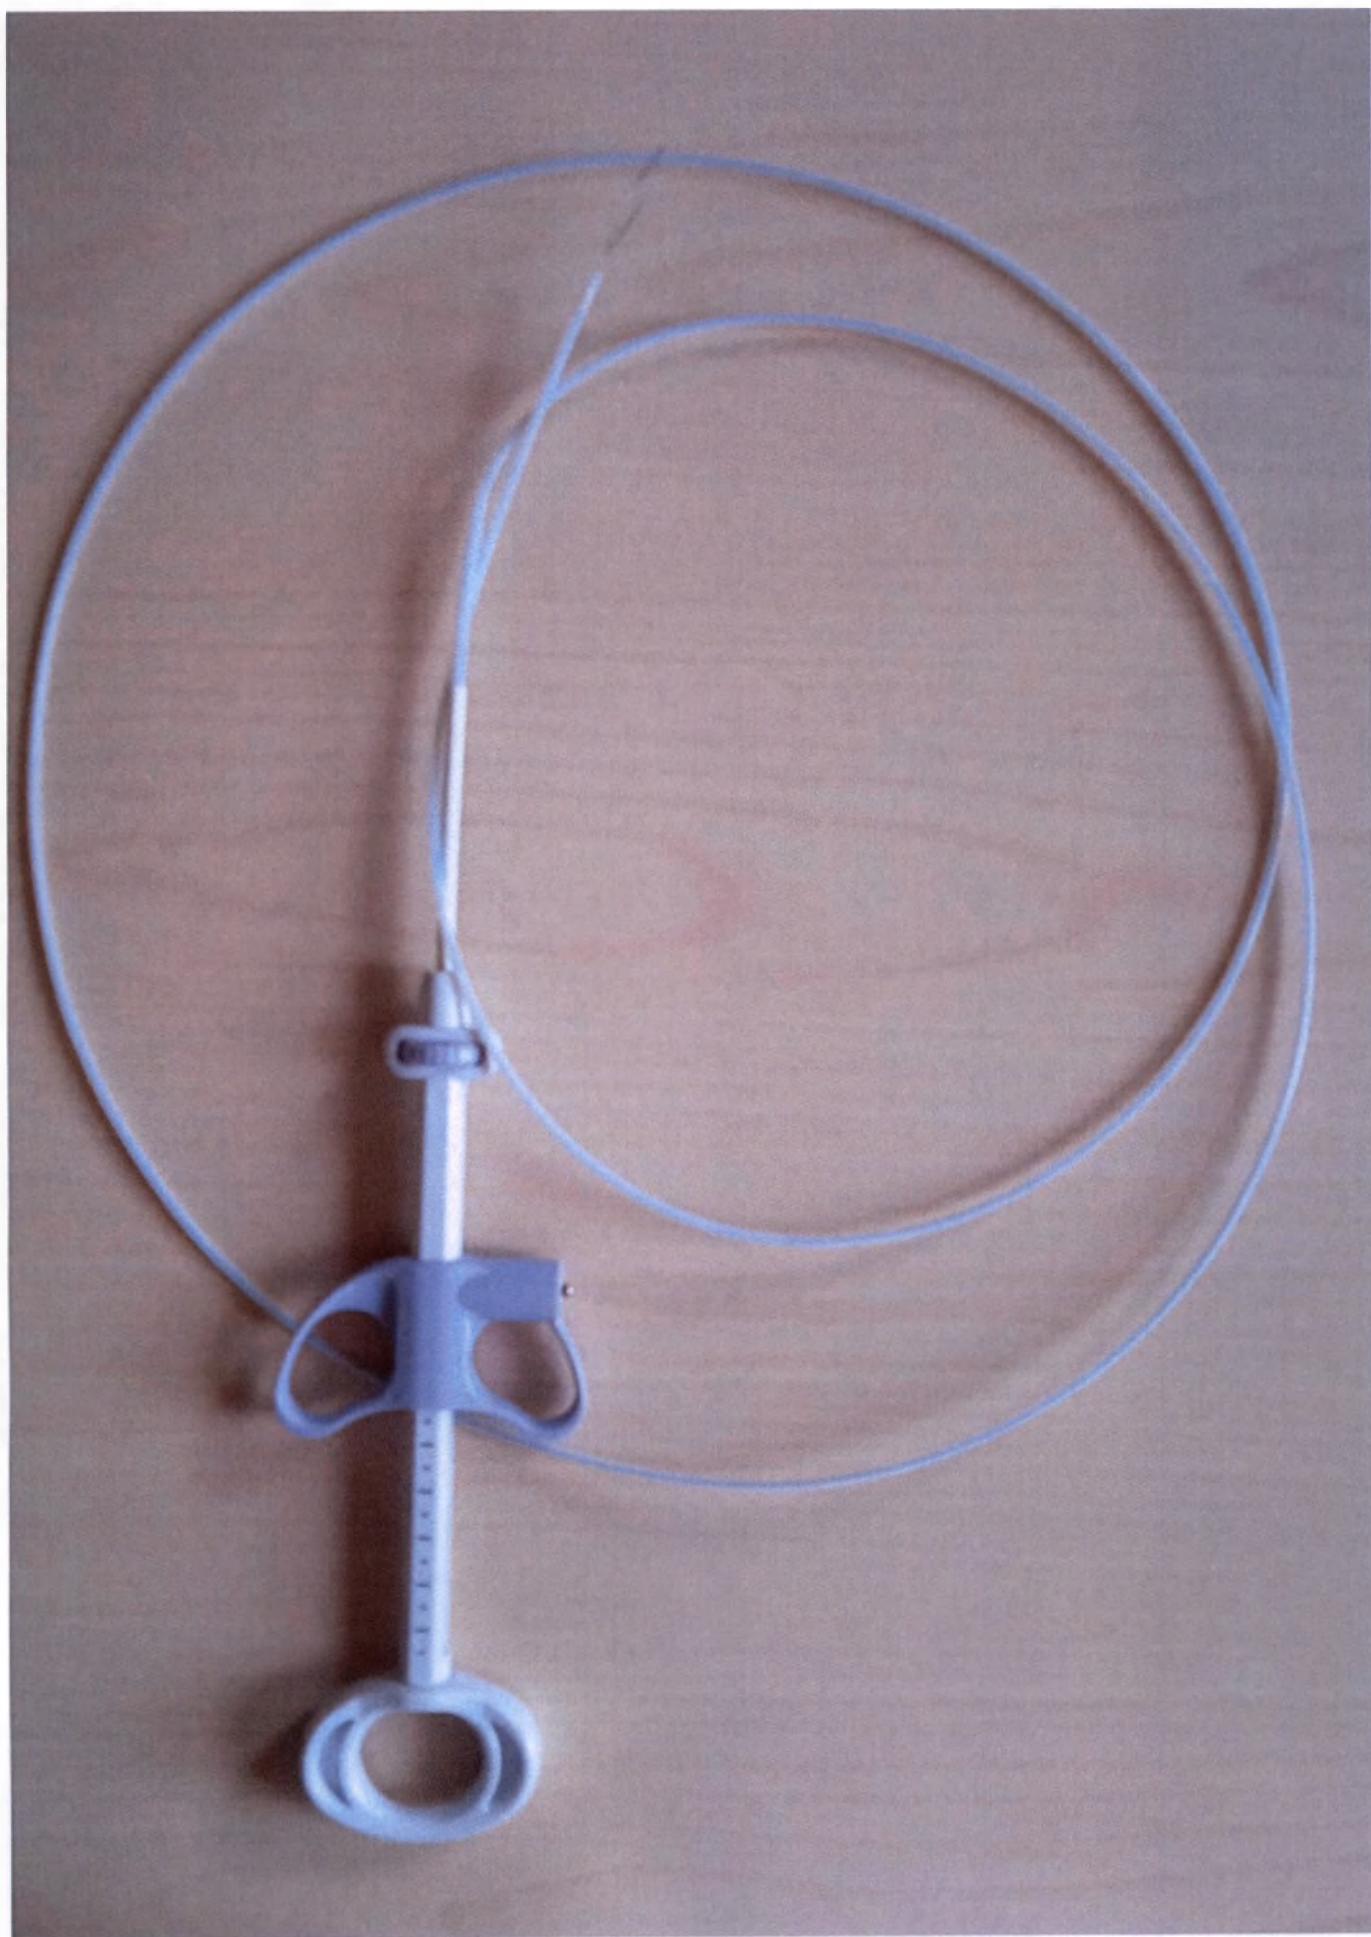

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-25 (в первичной упаковке)



2021/6/20 17:51

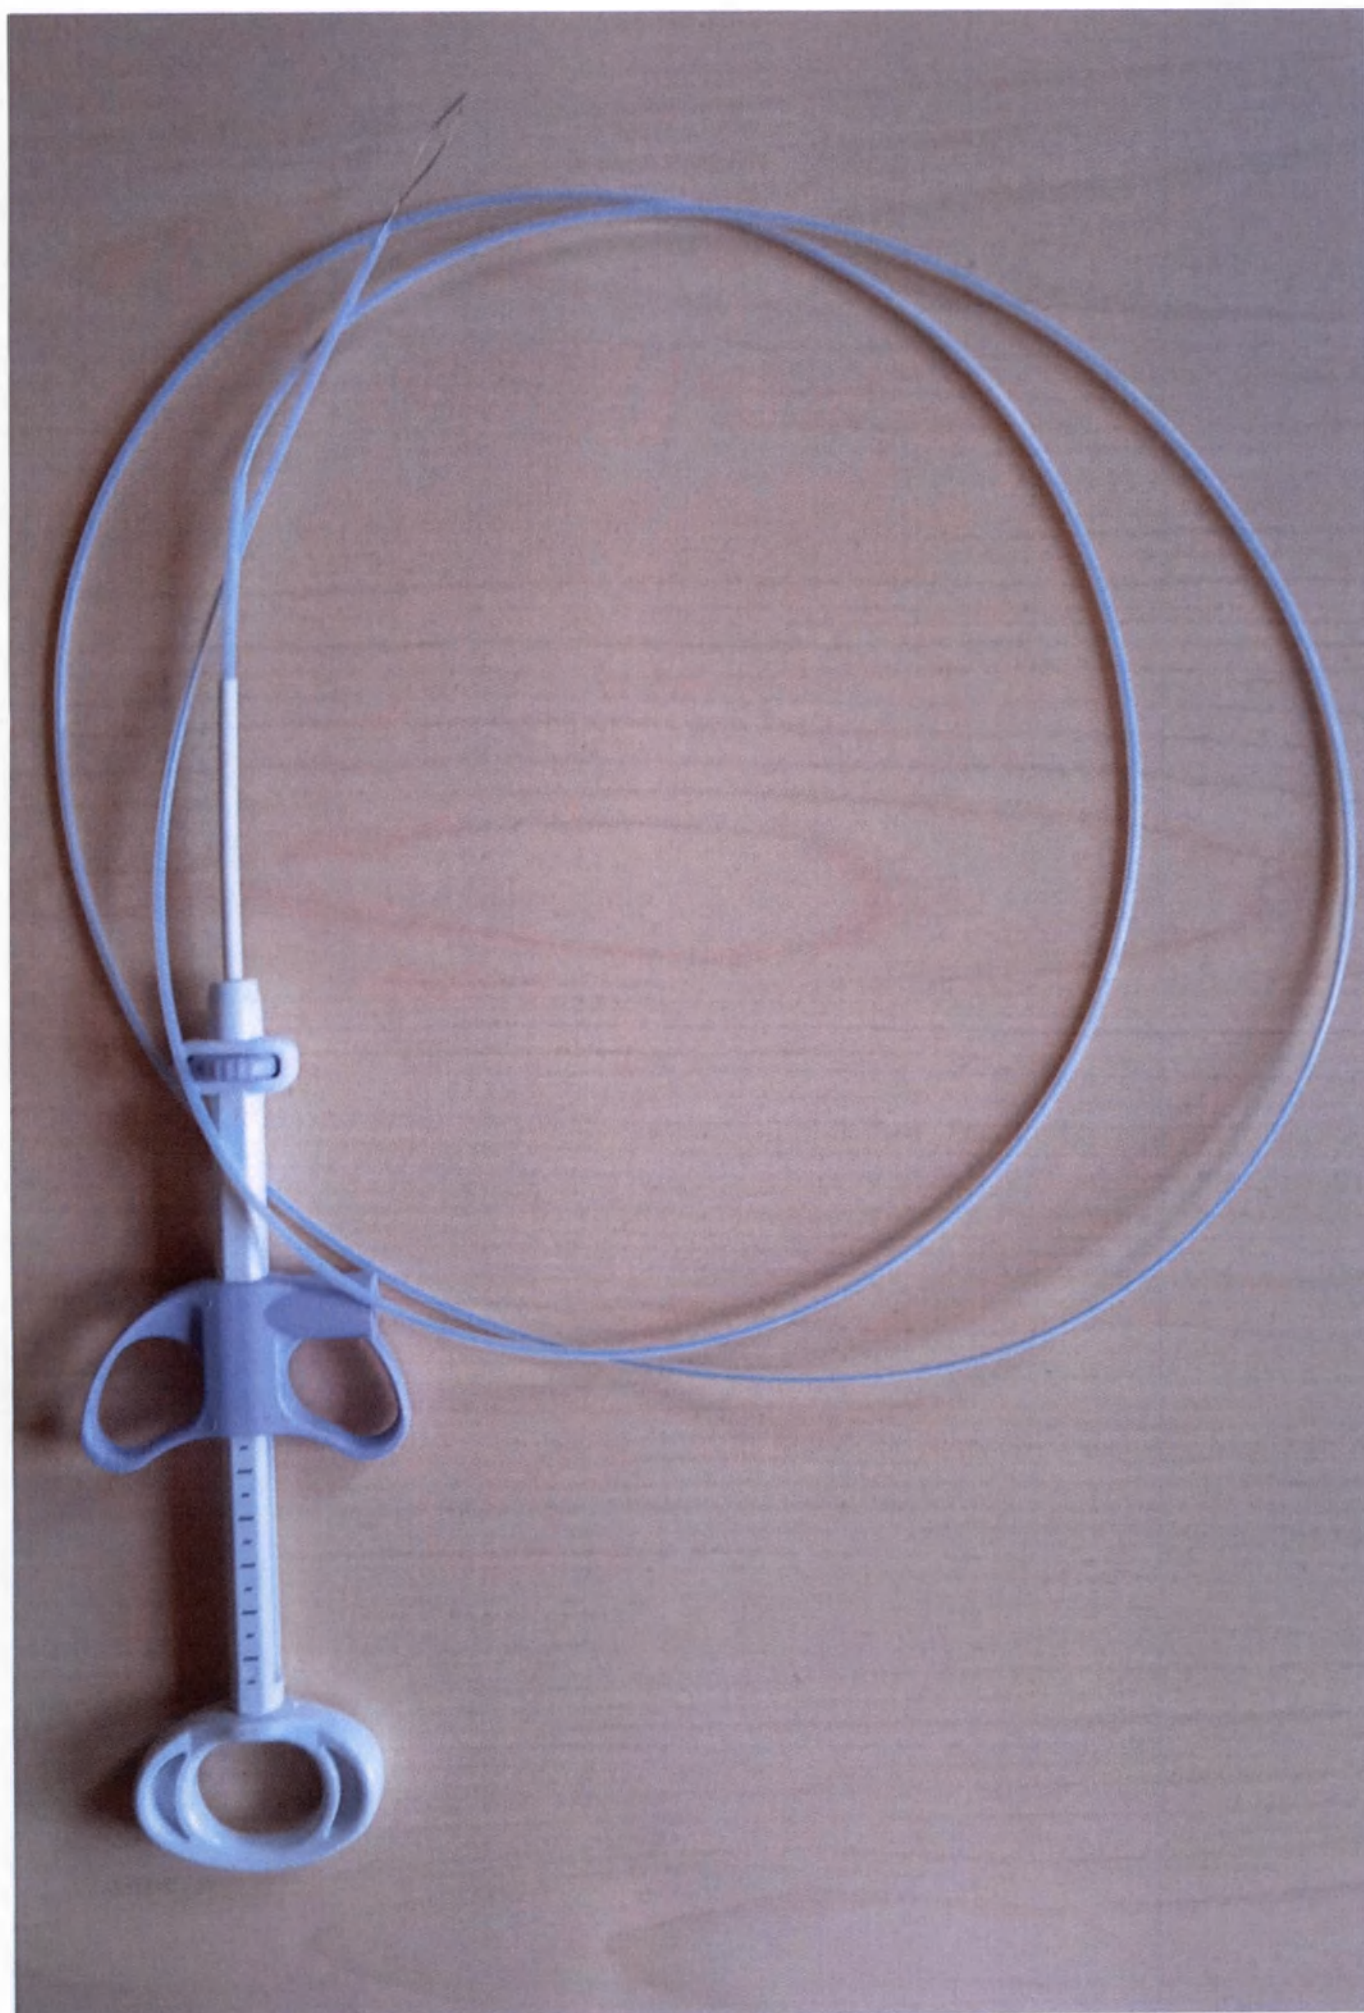

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-25 (в первичной упаковке)





Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-30




Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16R-30 (в первичной упаковке)




2021/6/20 17:56

Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN16R-30



2023-06-23 2020-06-24

LOT 170STJJF22F23




Optimos™ Polypectomy Snare




KSN16R-30 170STJJF22F23



KSN16R-30 170STJJF22F23



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629



8 805253 839629





Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «овальная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-30 (в первичной упаковке)


2021/6/20 17:58



Перли Ordinos для полипектомин, тип «овальный», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23R-30 (во вторичной упаковке)


Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN23R - 30



2023-06-23 2020-06-24

LOT 170STEJF22F23



Optimos™ Polypectomy Snare



Optimos™ Polypectomy Snare



RESEARCH DESIGN AND METHODS

8 809234 3373



TaeWoong
MEDICAL

Tekung Medical Co., Ltd. | HPI Healthcare Group Ltd. | 신우시 불광면 고동로 84
16, Gyeonggi-do, Yongin-si, Korea 10022
Gyeonggi-do, Korea 10022
Tel : +82(7)590-0547~4, Fax : +82(7)590-0548

LB17 - 02(Rev 04) 2020.01.10 EMENDO EUROPE Privateaapwacht 20 2014 AP The Hague The Netherlands

GS1-128 (UCC / EAN-128)



GS1-128 (UCC / EAN-128)




GS1-128 (UCC / EAN-128)



TaeWoong
MEDICAL



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN16H-10

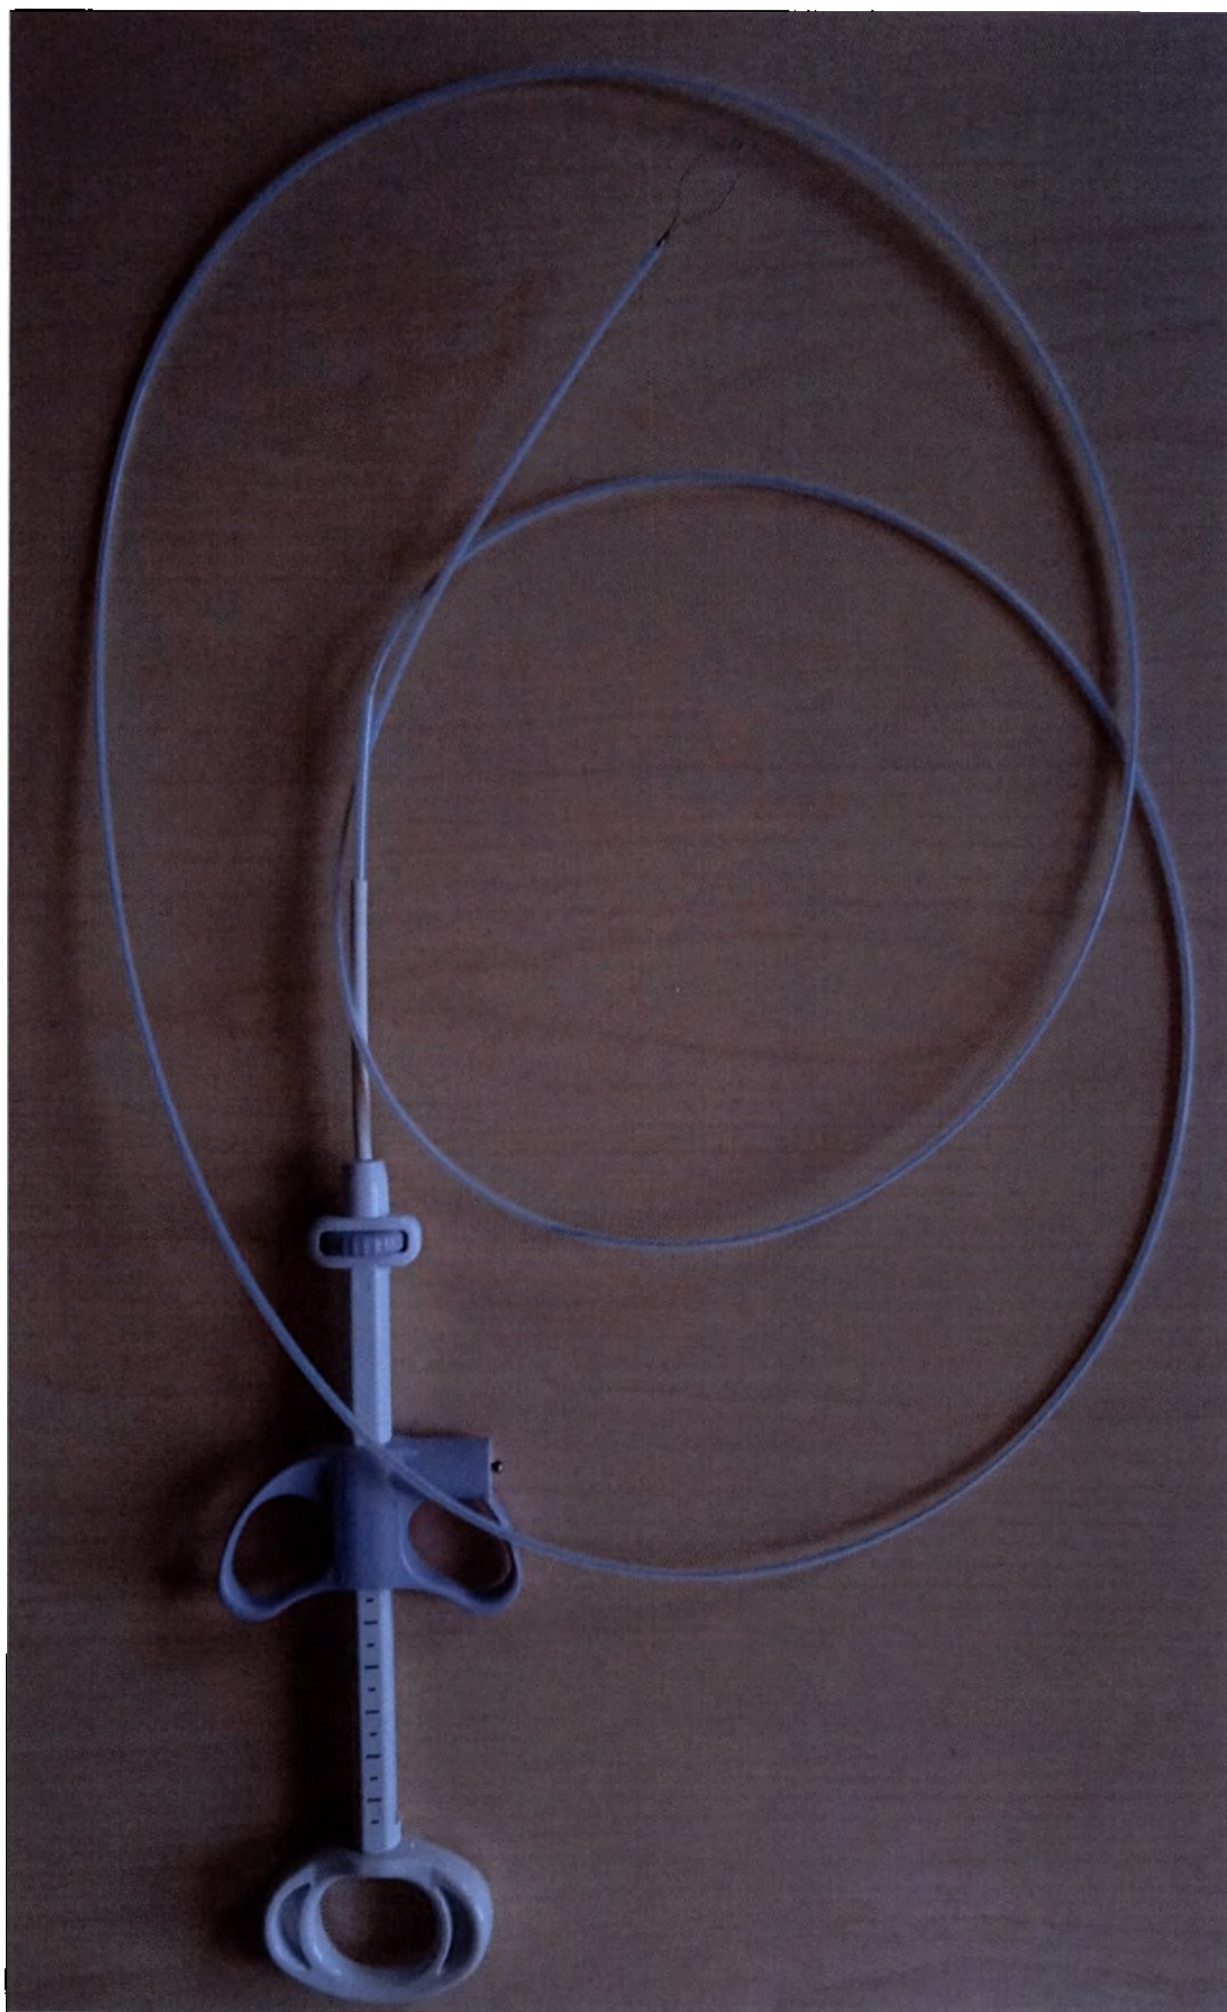


[illegible]

122

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-10 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-10

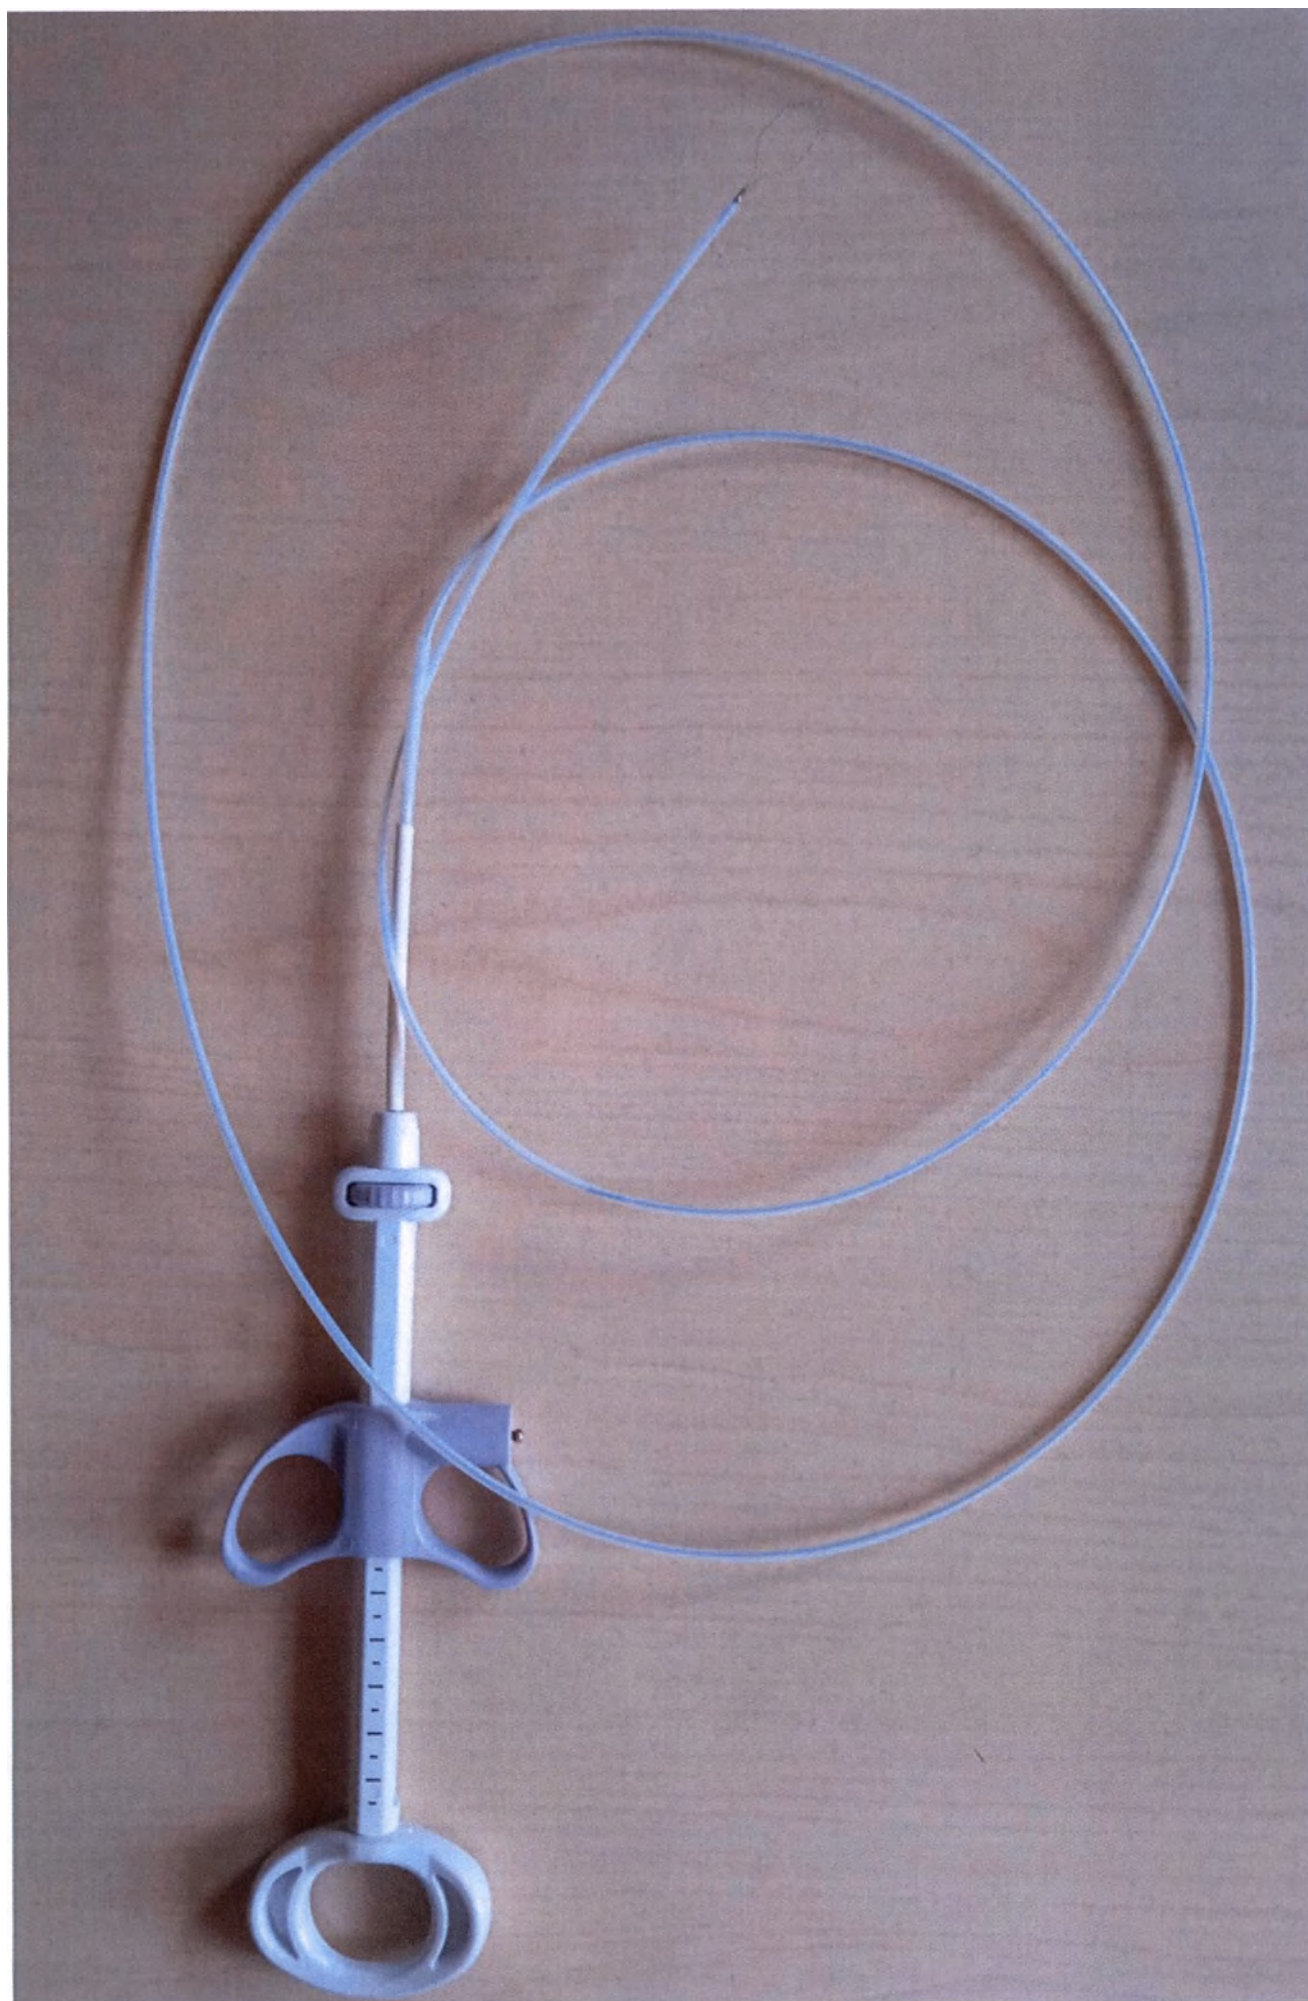

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-10 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-10 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-15




Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-15 (в первичной упаковке)


2021/6/20 18:07



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-15 (во вторичной упаковке)

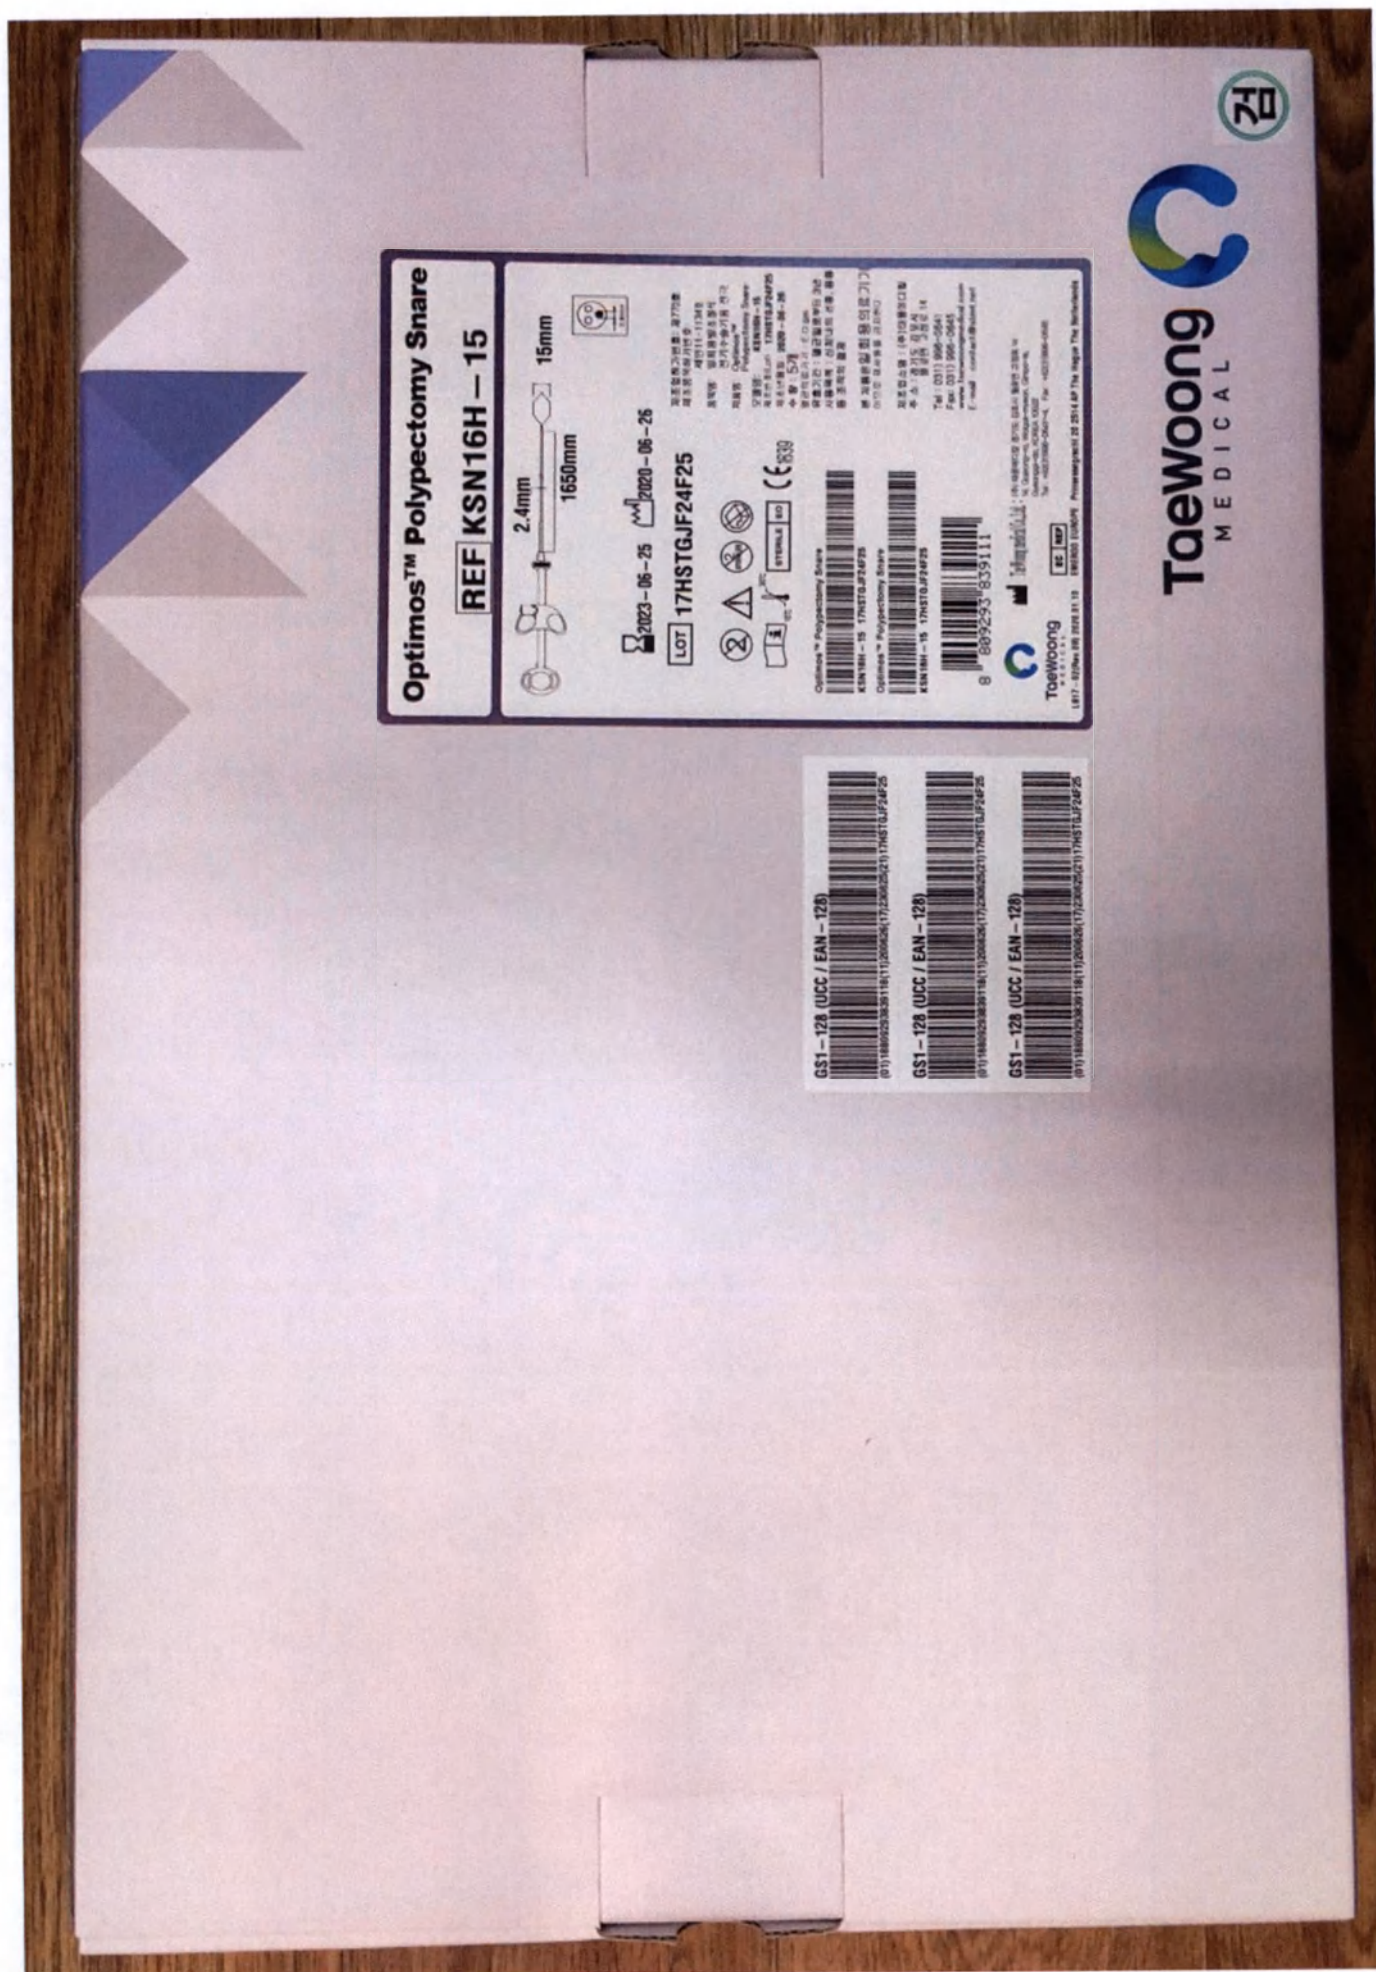

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-15

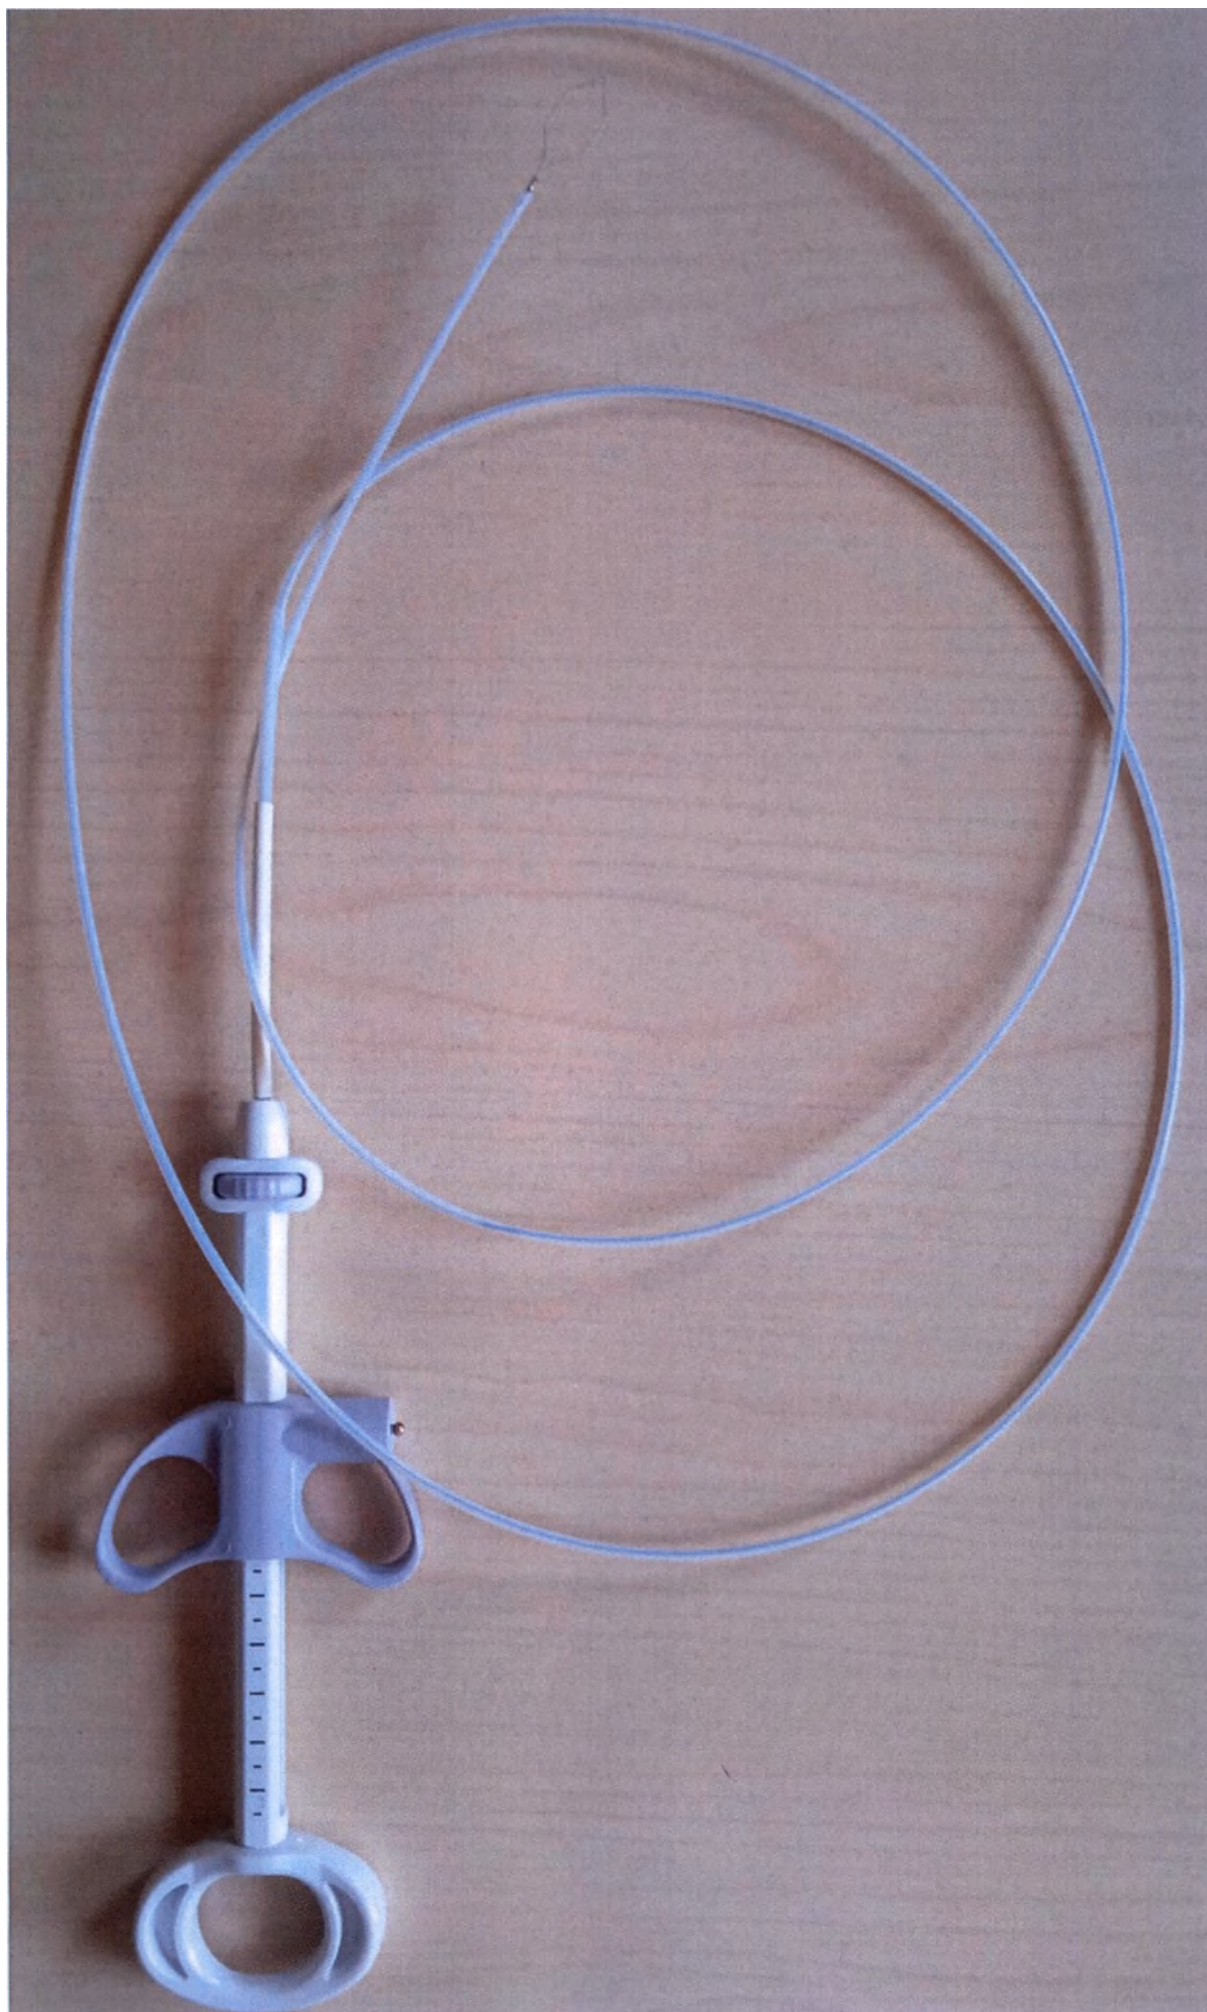

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-15 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-15 (во вторичной упаковке)

Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN23H-15

2023-06-25 2020-06-26

LOT 17HSTBJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)
 (01)18809252839156(11)220626(17)2306252(21)17HSTBJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)
 (01)18809252839156(11)220626(17)2306252(21)17HSTBJF24F25

GS1-128 (UCC / EAN - 128)
 (01)18809252839156(11)220626(17)2306252(21)17HSTBJF24F25

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23H-15 17HSTBJF24F25
 Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23H-15 17HSTBJF24F25

8 809253 839159
 18809252839156(11)220626(17)2306252(21)17HSTBJF24F25

TaeWoong
 1871-032841-00 020 01 15
 1871-032841-00 020 01 15
 1871-032841-00 020 01 15




Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестигуговая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-20



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-20 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-20 (во вторичной упаковке)

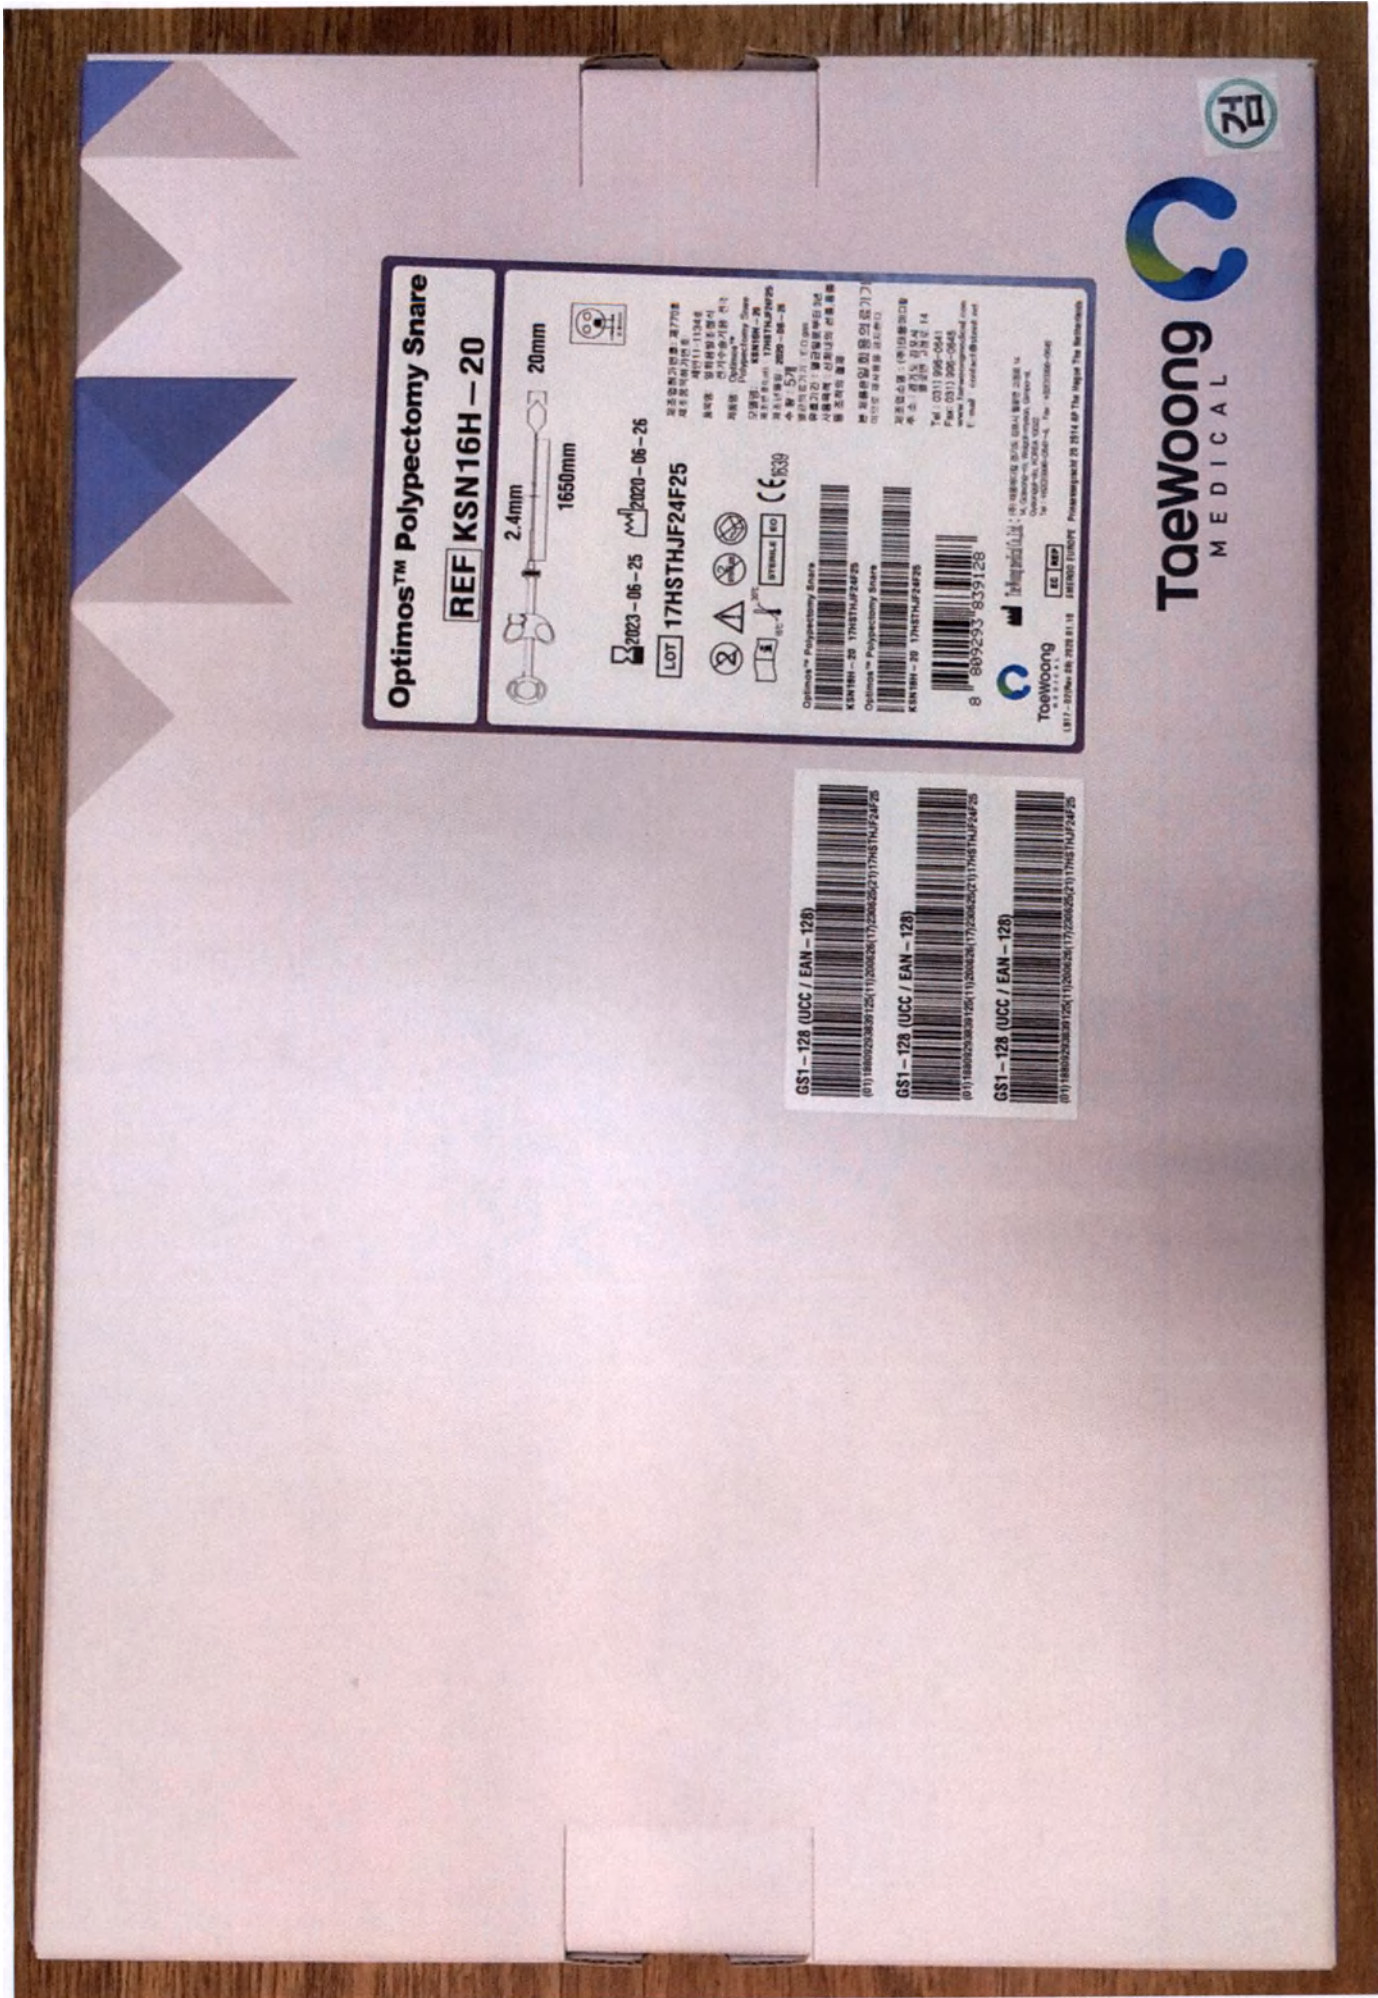

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-20



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-20 (в первичной упаковке)



138



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-25



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-25 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-25(во вторичной упаковке)




TaeWoong
MEDICAL

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-25



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-30

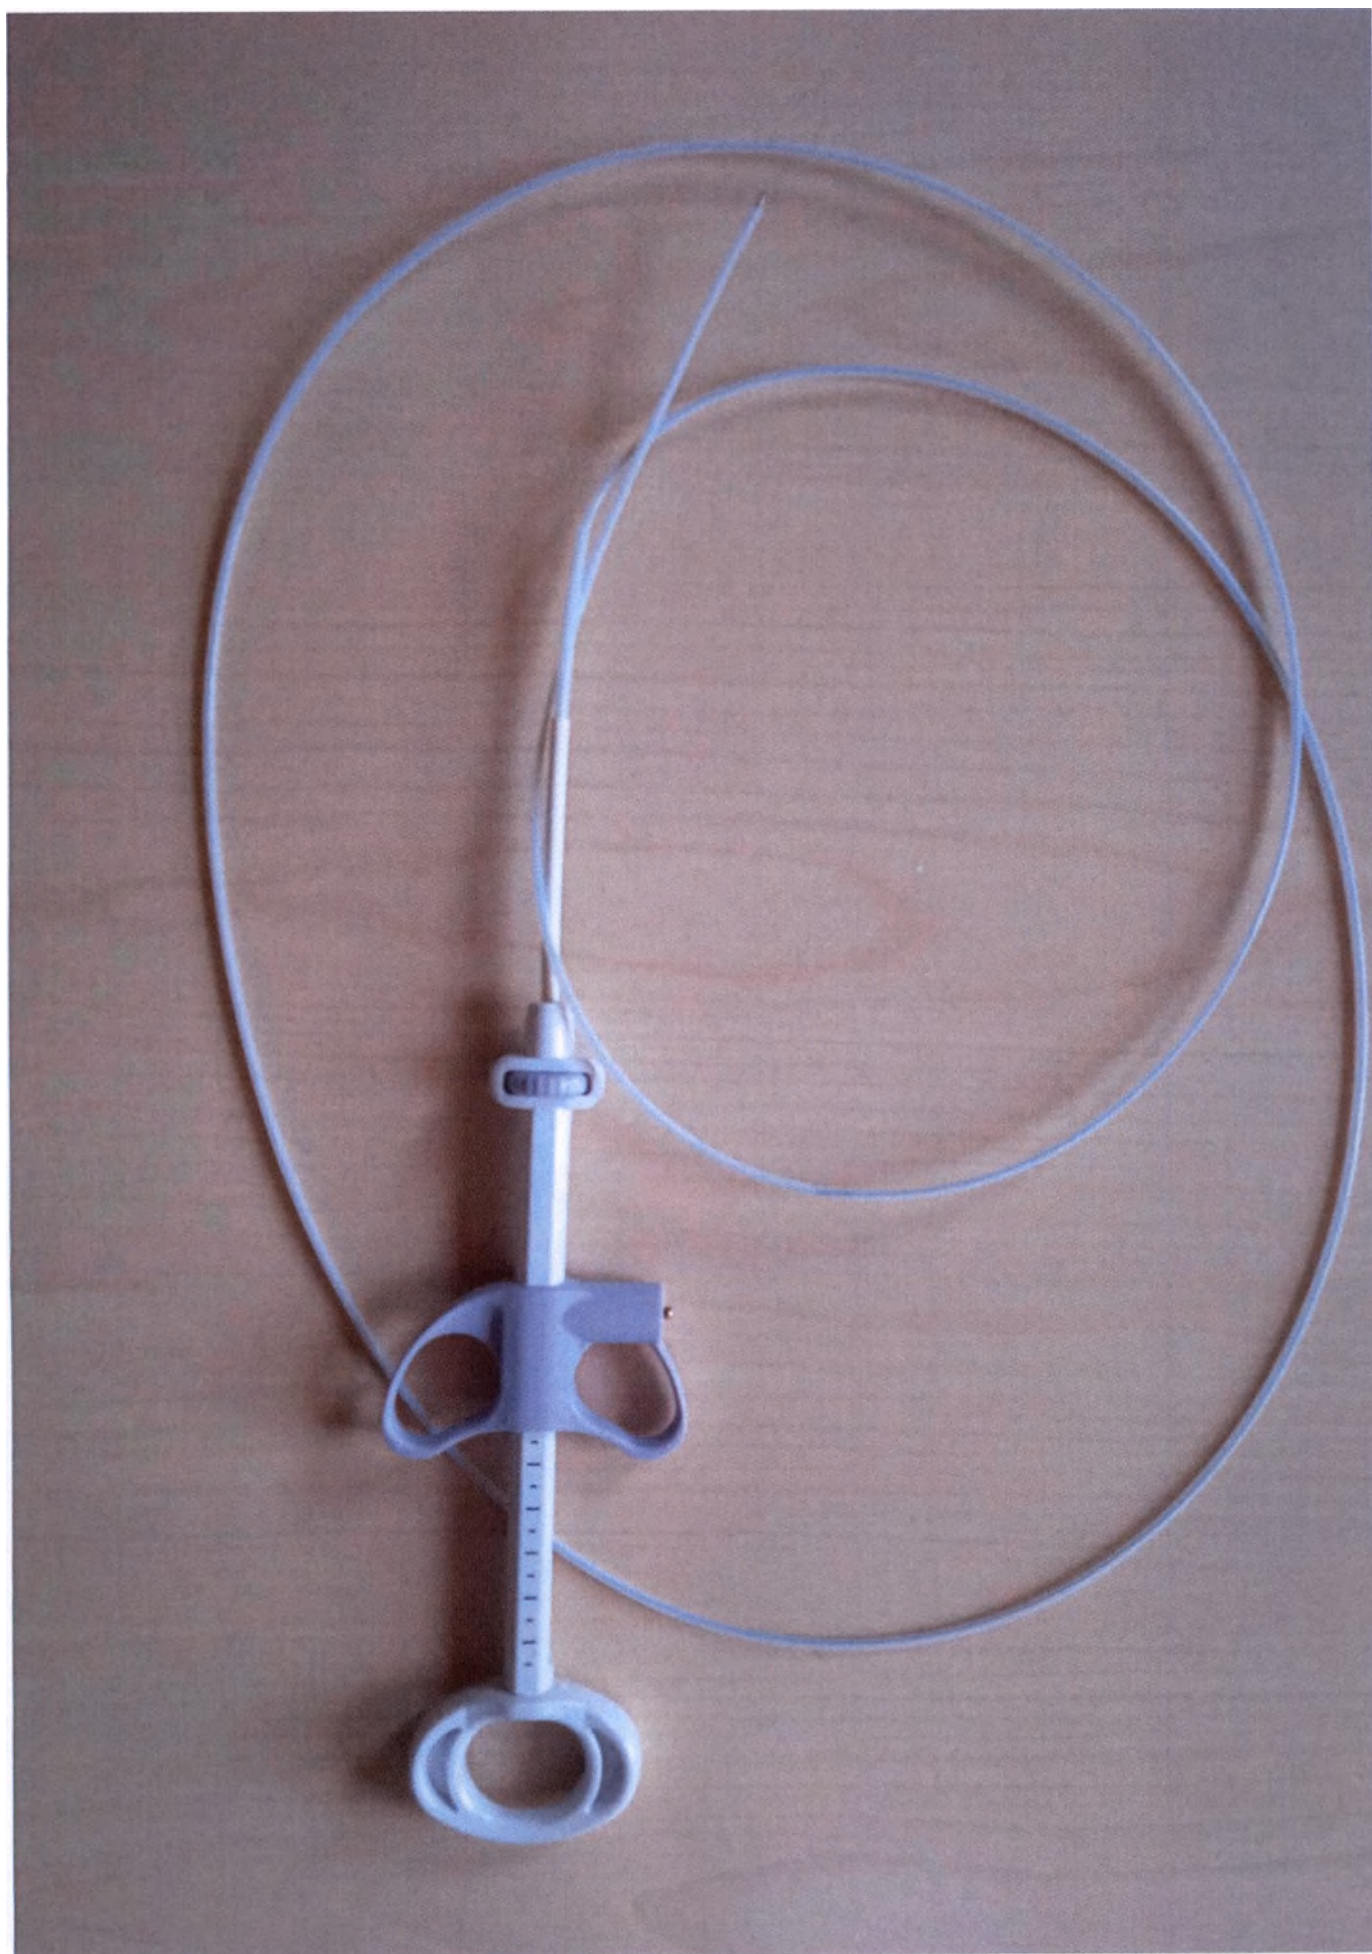

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16H-30 (в первичной упаковке)


2021/6/20 18:20



вариант исполнения: KSN16H-30 (во вторичной упаковке)



2021/6/20 18:22

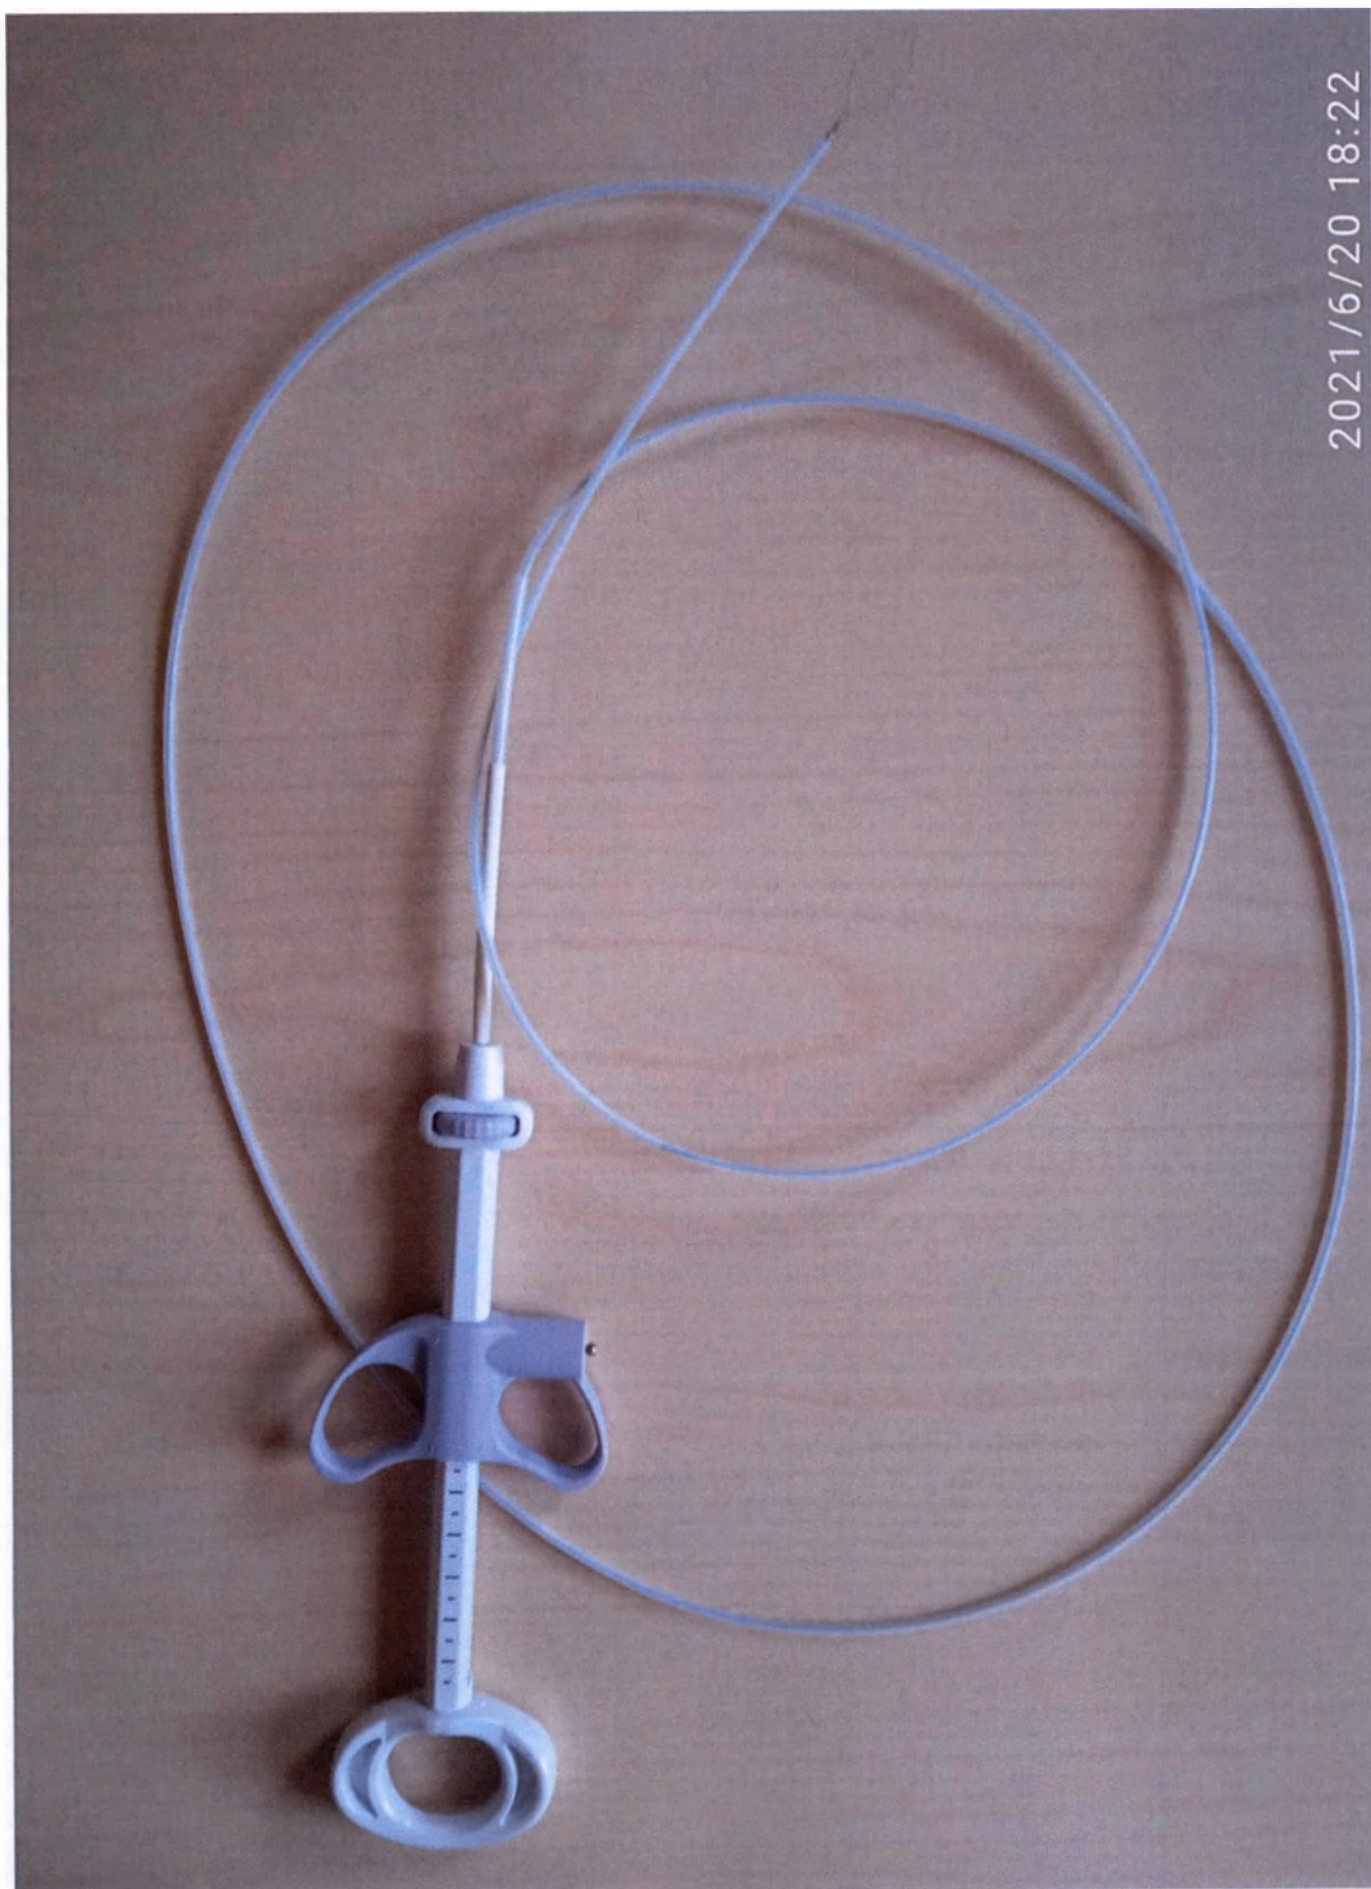

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23H-30 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «шестиугольная», в комплекте с инструкцией по применению,
вариант исполнения: KSN23H-30 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «ассиметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16D-15



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16D-15 (в первичной упаковке)



2021/6/20 18:

[illegible]

Taewoong
MEDICAL



GS1 - 128 (UCC / EAN - 128)

(81) 18002530365441 (1)280704 (17)23670 (21)11705 (1)504007

GS1 - 128 (UCC / EAN - 128)

(81) 18002530365441 (1)280704 (17)23670 (21)11705 (1)504007

GS1 - 128 (UCC / EAN - 128)

(81) 18002530365441 (1)280704 (17)23670 (21)11705 (1)504007

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «ассиметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-15




Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-15 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-15 (во вторичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16D-25

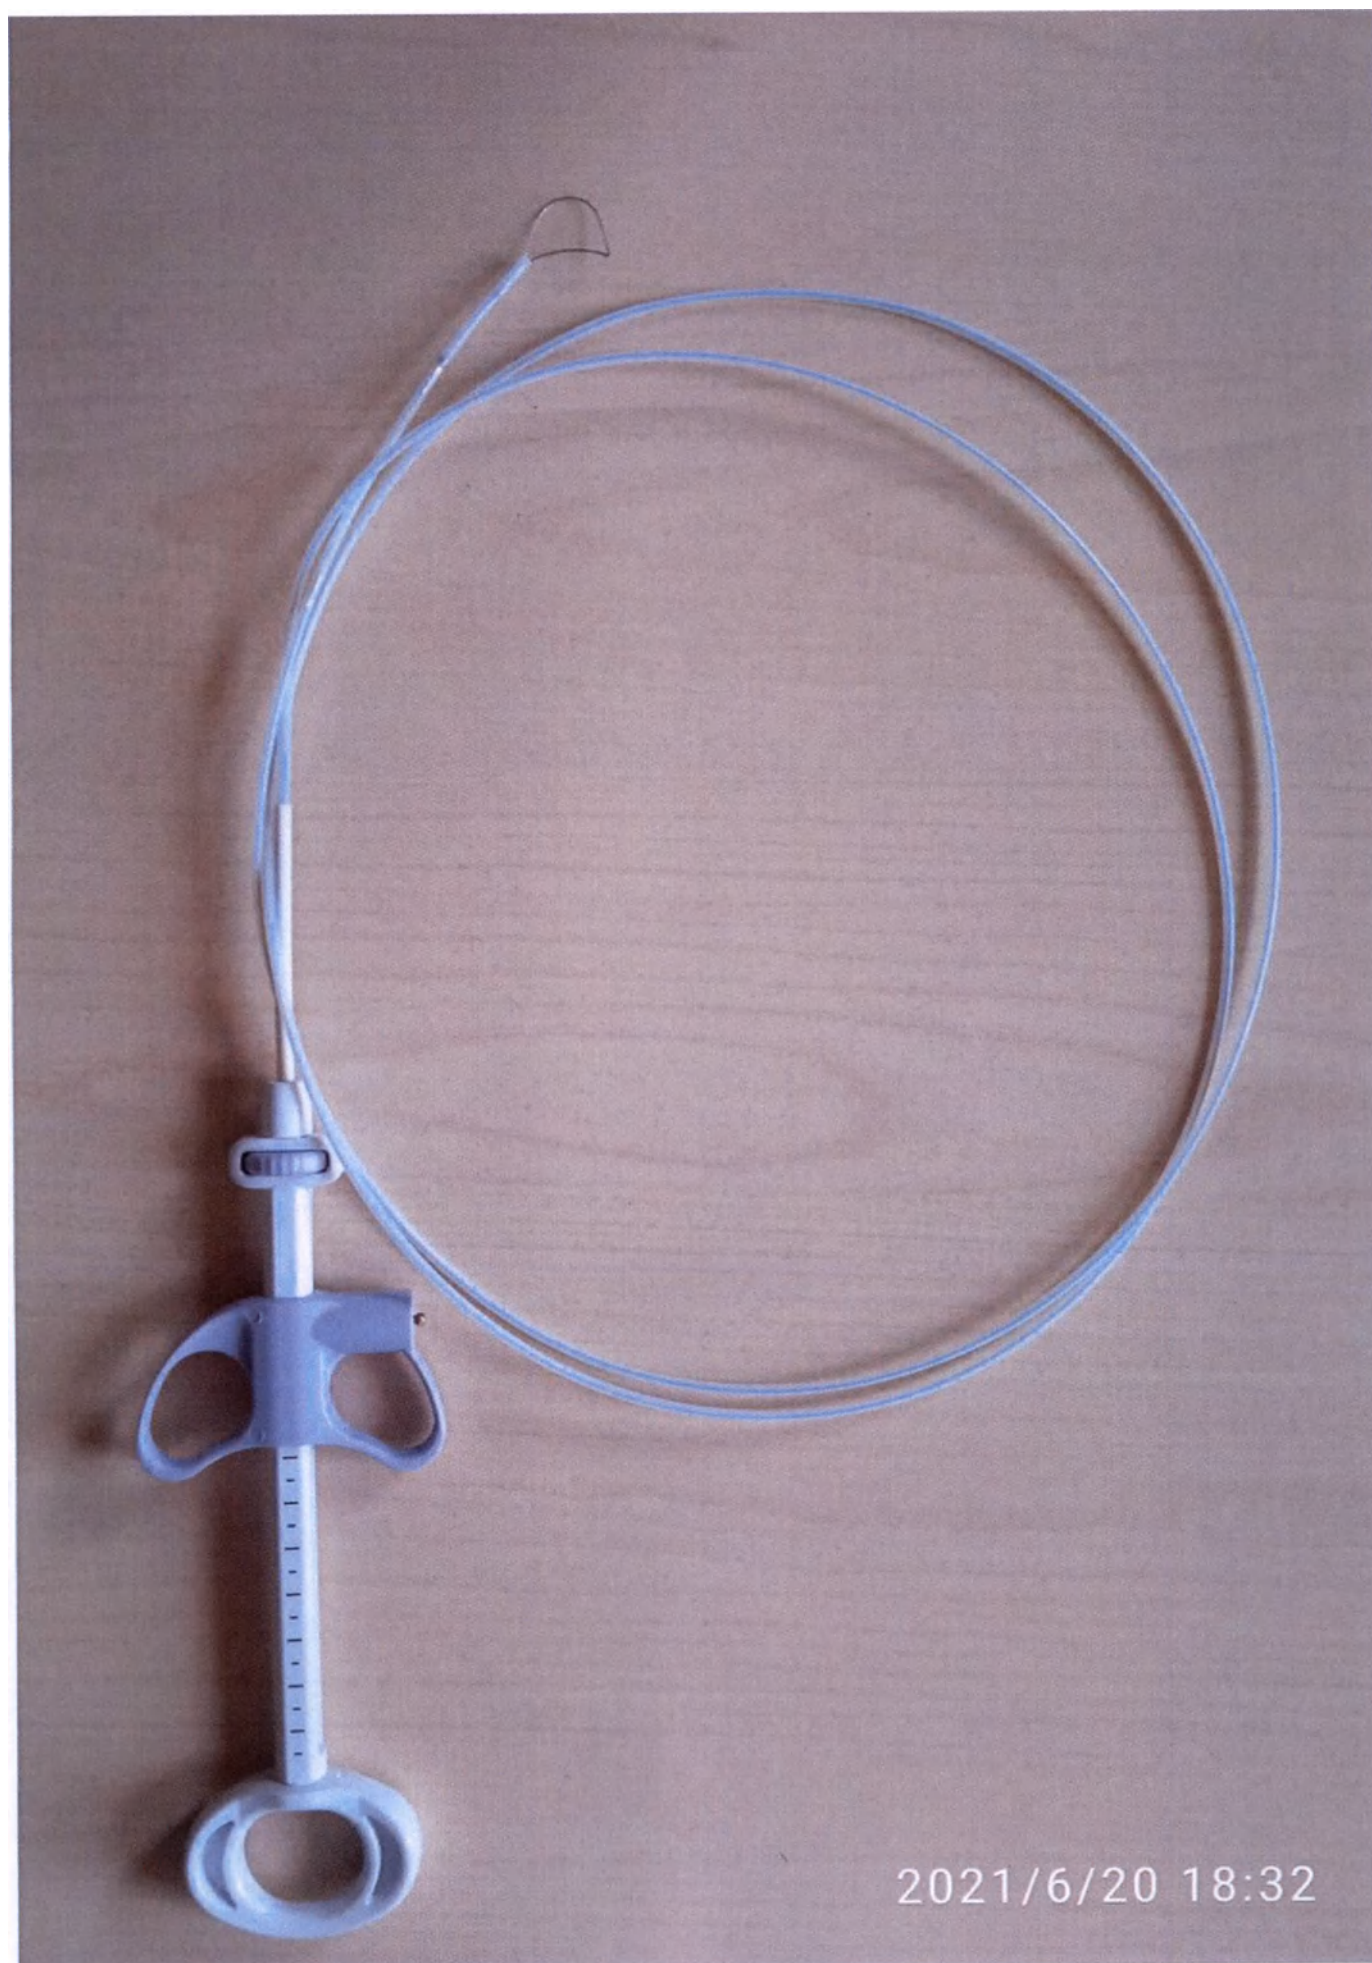

2021/6/20 18:32

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «ассиметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN16D-25 (в первичной упаковке)



Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN16D-25

2.4mm 25mm 1650mm

LOT 17DSTIJG06G07

2023-07-07 2020-07-08

Optimos™ Polypectomy Snare

17DSTIJG06G07

8 889323 859067

Optimos™ Polypectomy Snare

17DSTIJG06G07

8 889323 859067

Optimos™ Polypectomy Snare

17DSTIJG06G07

8 889323 859067

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)


GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

GS1-128 (UCC / EAN-128)

REF KSN16D - 25




0.5mm

1650mm

2023-07-07 2020-07-08

LOT 17DSTIJG06G07



Dynamag™ Polyethylene Sulfate

0-7638-9000-0

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1-800-368-2767

8 699297 879677

03

11-10 00707 000 000/12
 - 02700 000 70700 01 10
 EC REP
 11-10 00707 000 000/12

1

W


Web

MED

10

100

GS1-128 (UCC / EAN-128)



1281-1286 / JGIM / Volume 15, November 2000

[illegible]

11) 18.006.29.00.00-4(11) 200 7084(17) 230 70

145

100


100

知



TaeWoong
MEDICAL


Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «ассиметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-25

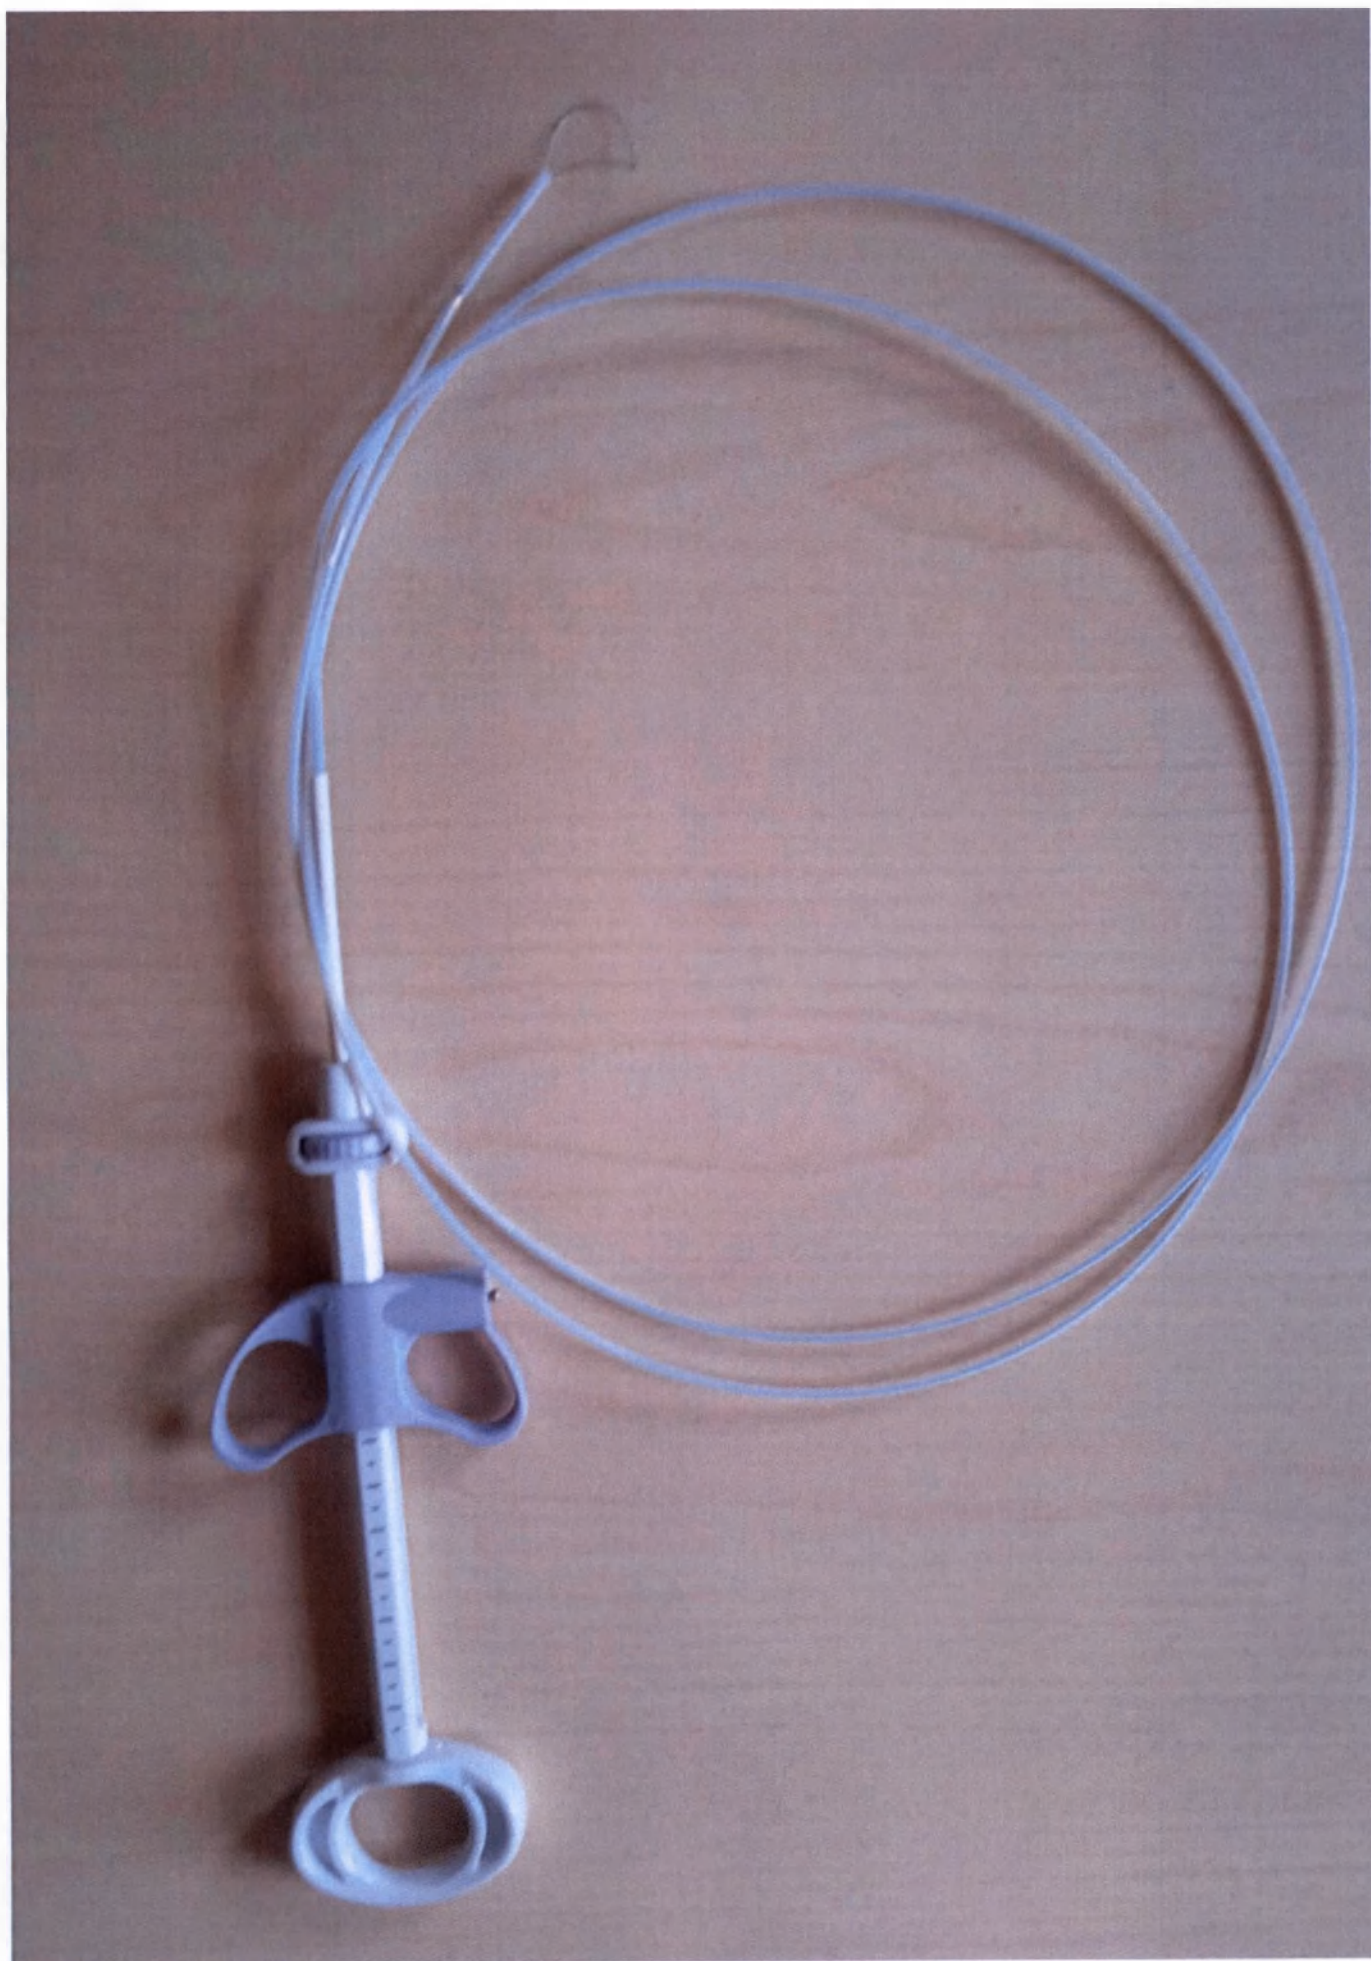

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «асимметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-25 (в первичной упаковке)



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «ассиметричная», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23D-25 (во вторичной упаковке)

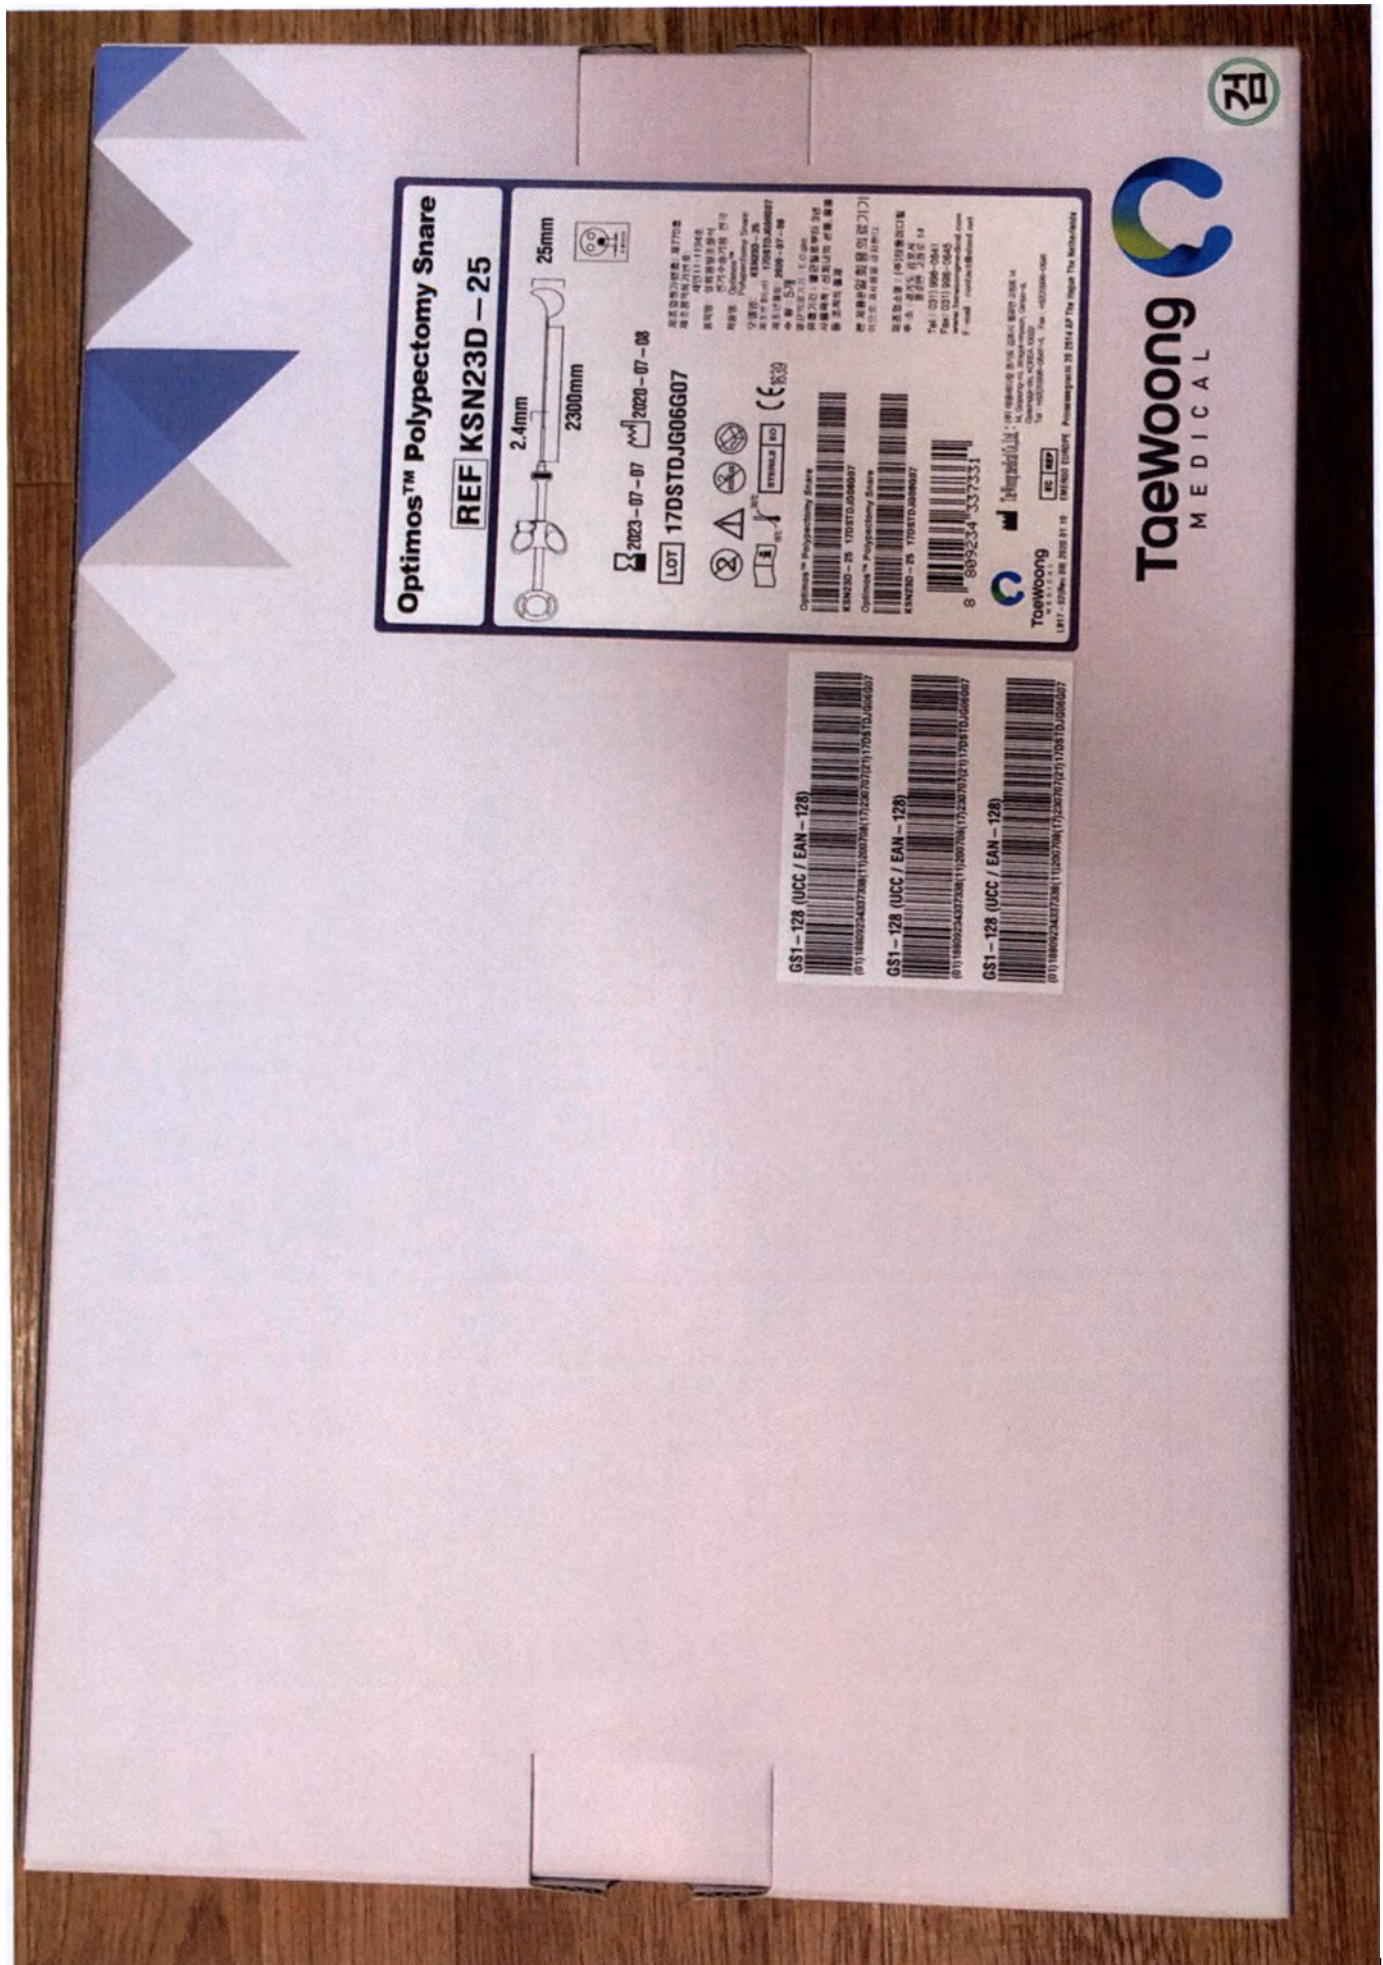





Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-10 (в первичной упаковке)

2021/6/20 18:41



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-10 (во вторичной упаковке)

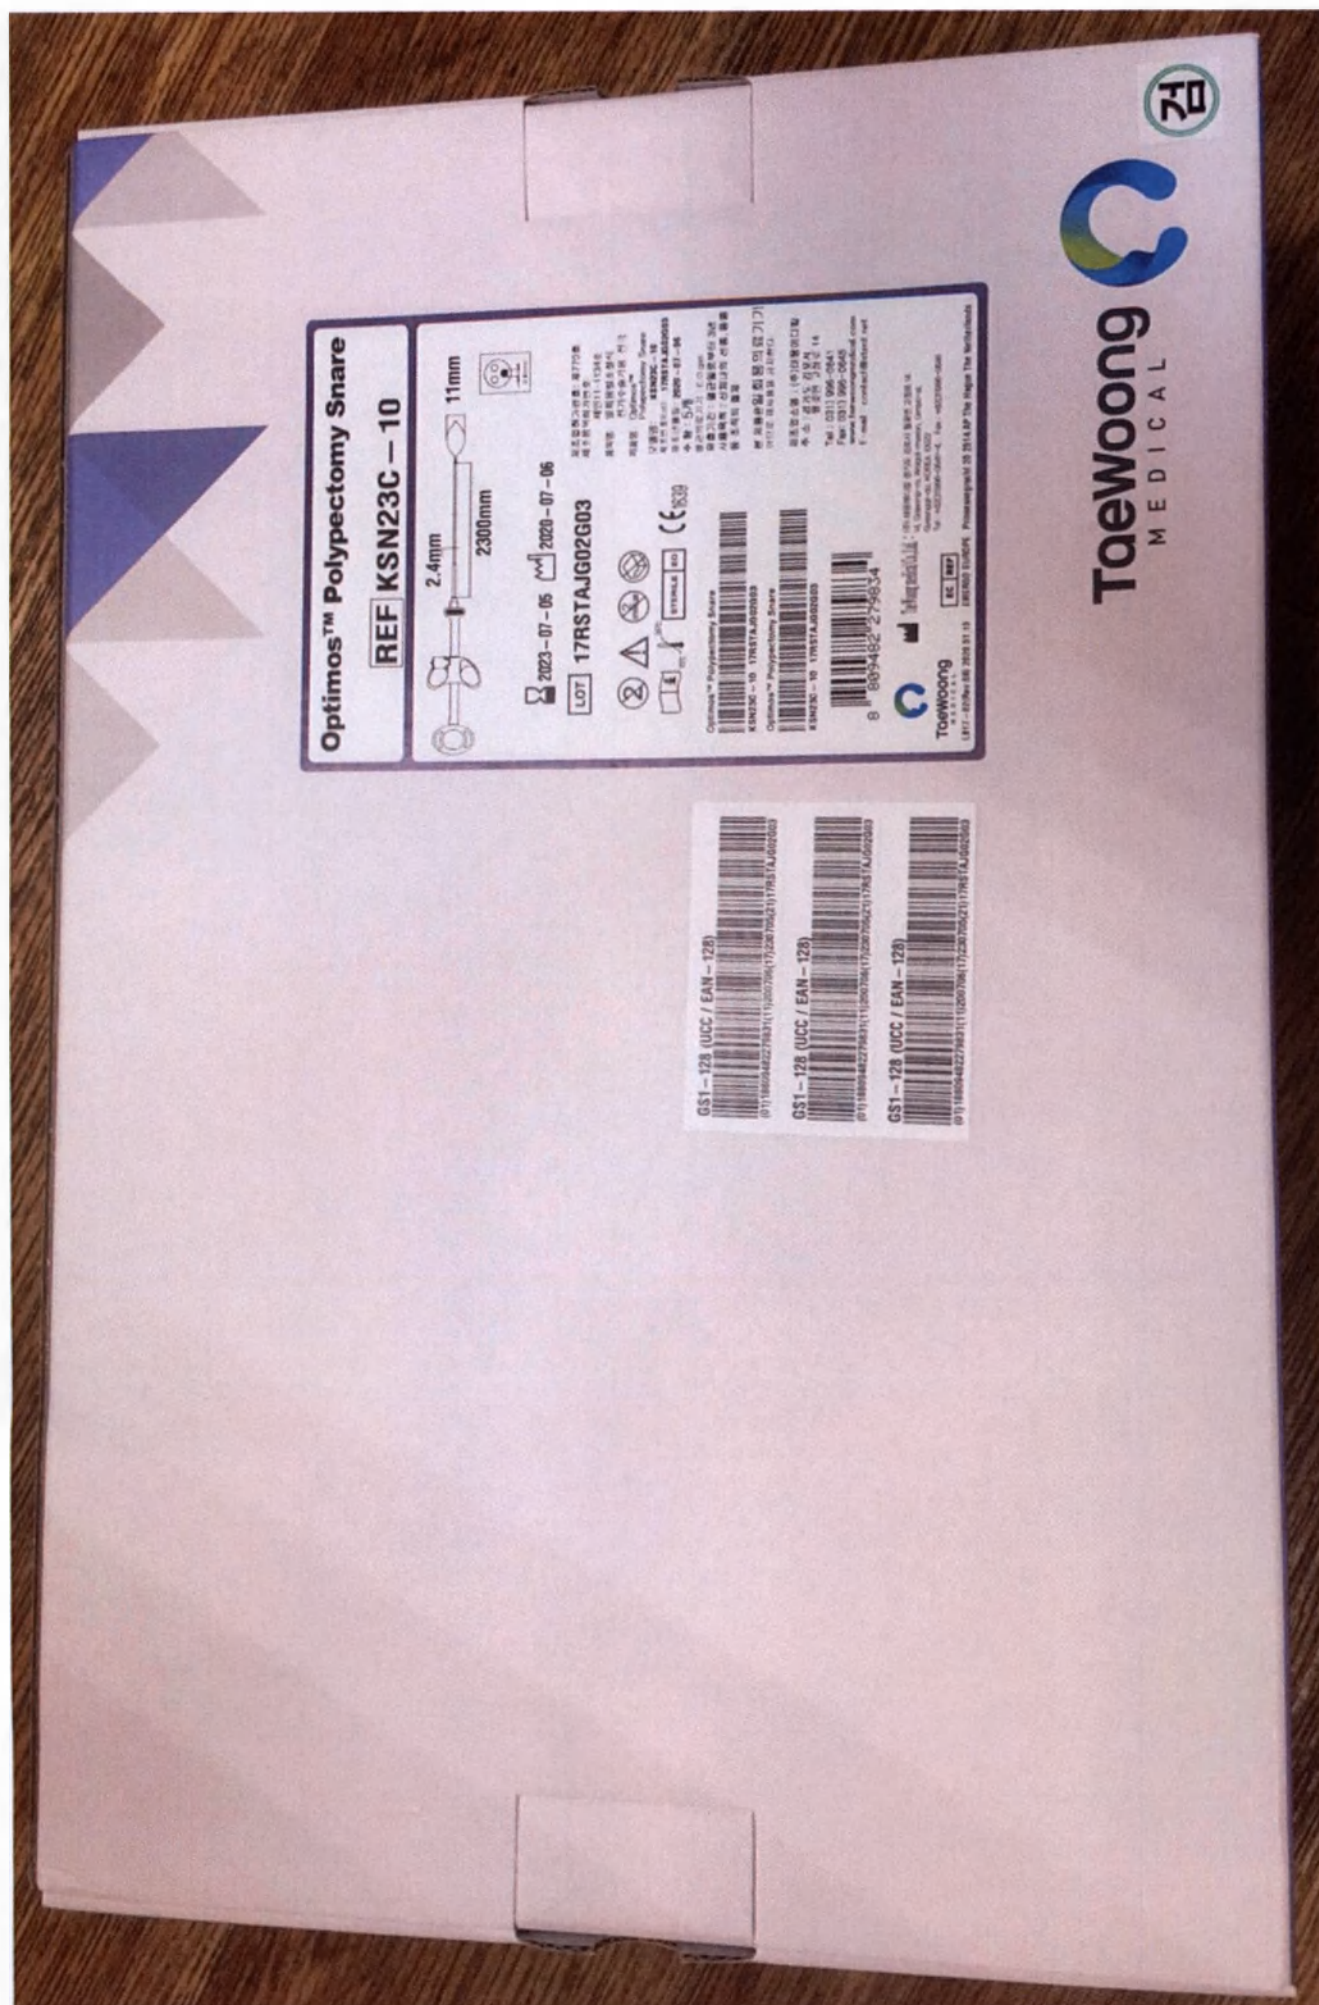

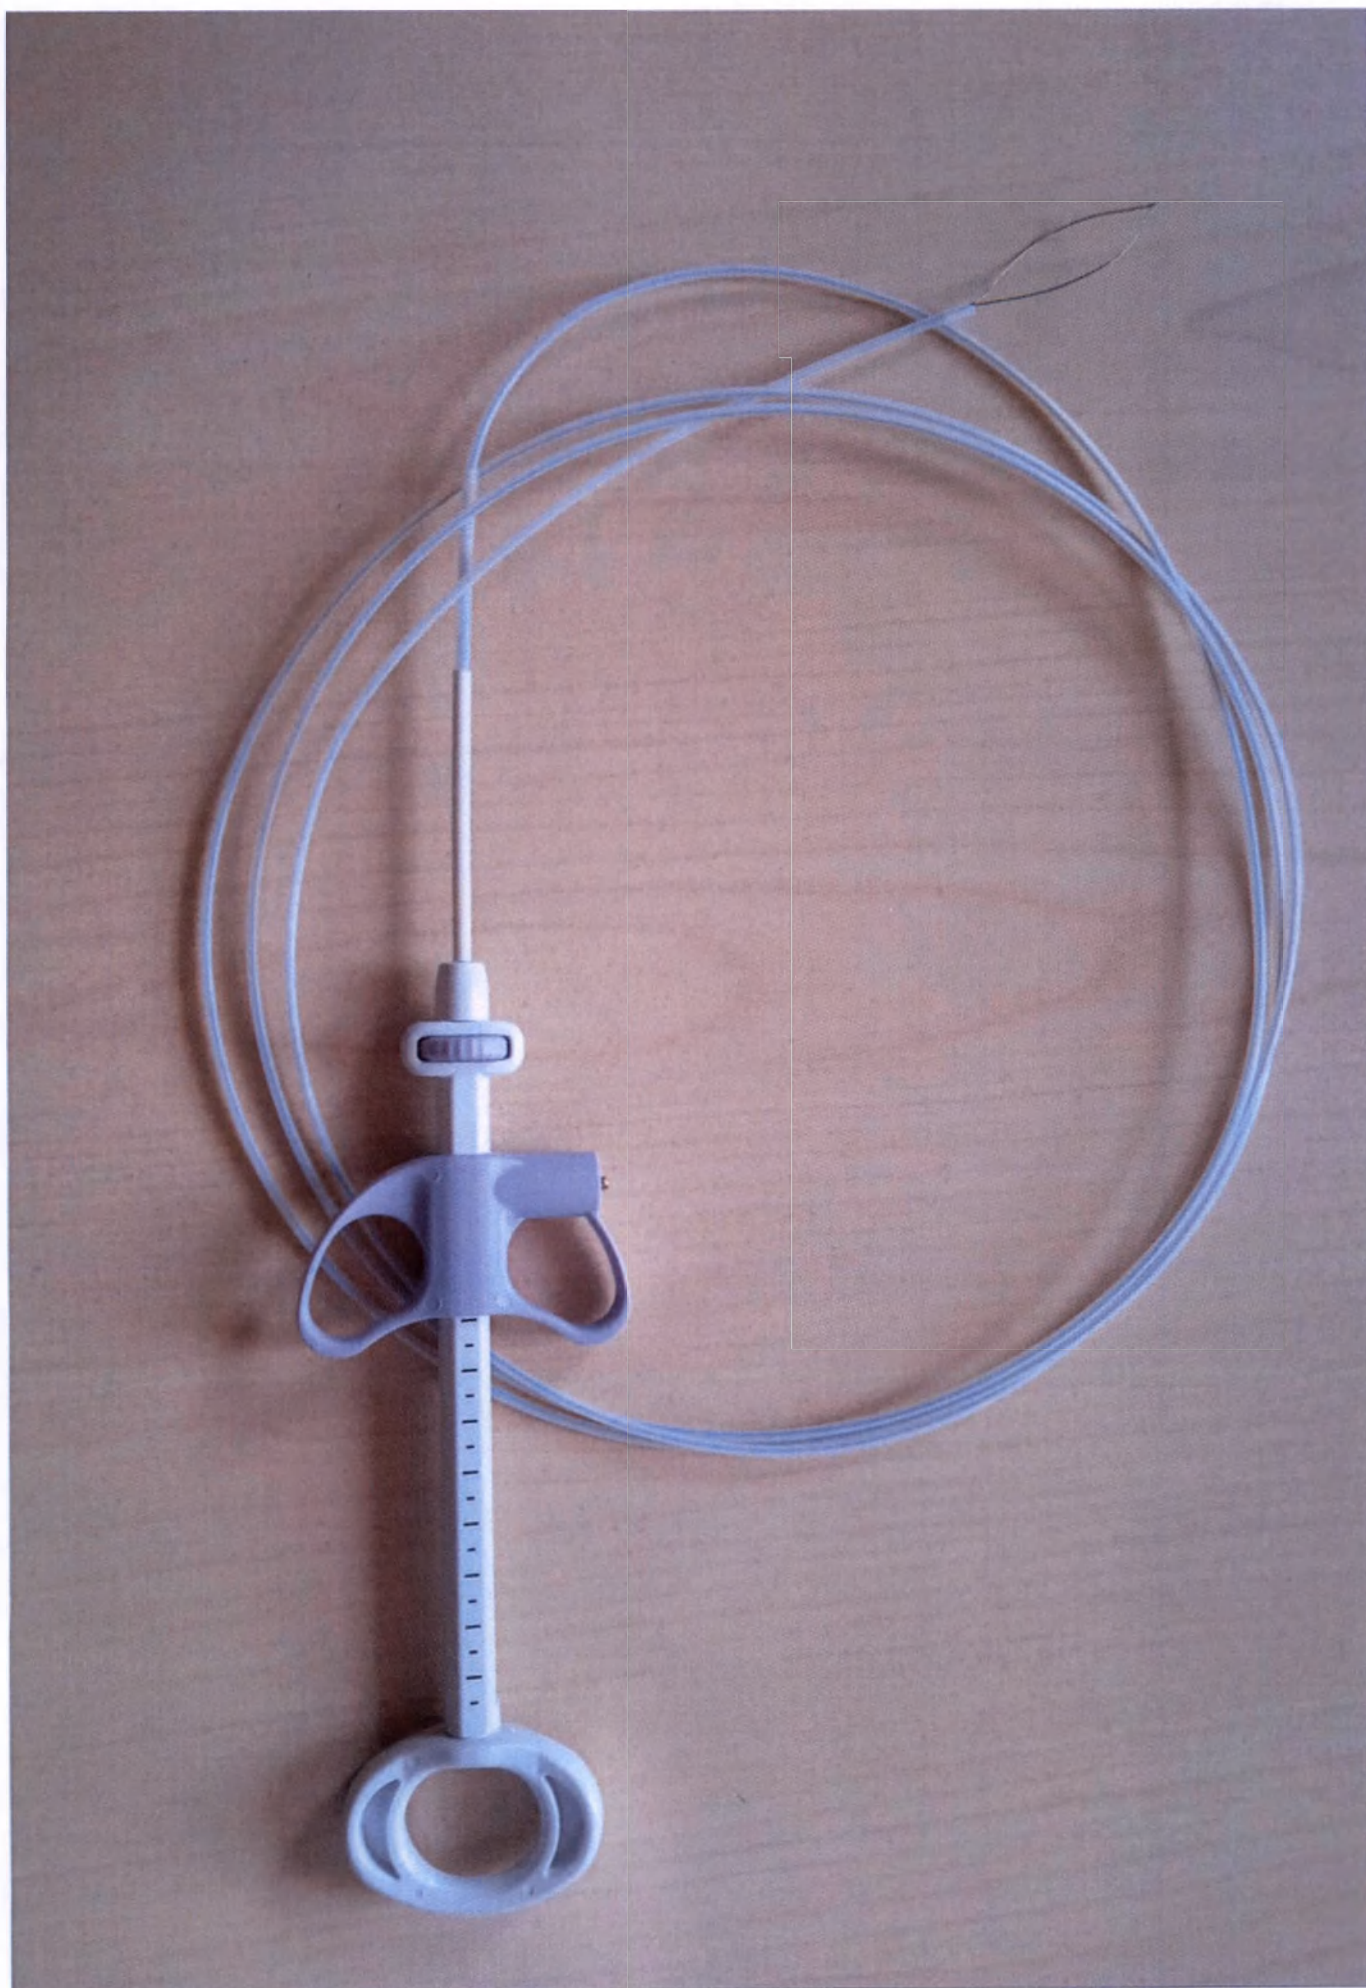


Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-15 (в первичной упаковке)

2021/6/20 18:43



Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN23C - 15



2023-07-05 2020-07-06

LOT 17RSTBJG02G03



Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C - 15 17RSTBJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C - 15 17RSTBJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C - 15 17RSTBJG02G03

8 809482 279797

TaeWoong Medical Co., Ltd.


1897-82Pae 48 925 81 18


EMERGO EUROPE P.O. Box 2514 BP The Hague The Netherlands

GS1-128 (UCC / EAN-128)



(01)08905482279797(1)020706(17)230705(21)17RSTBJG02G03

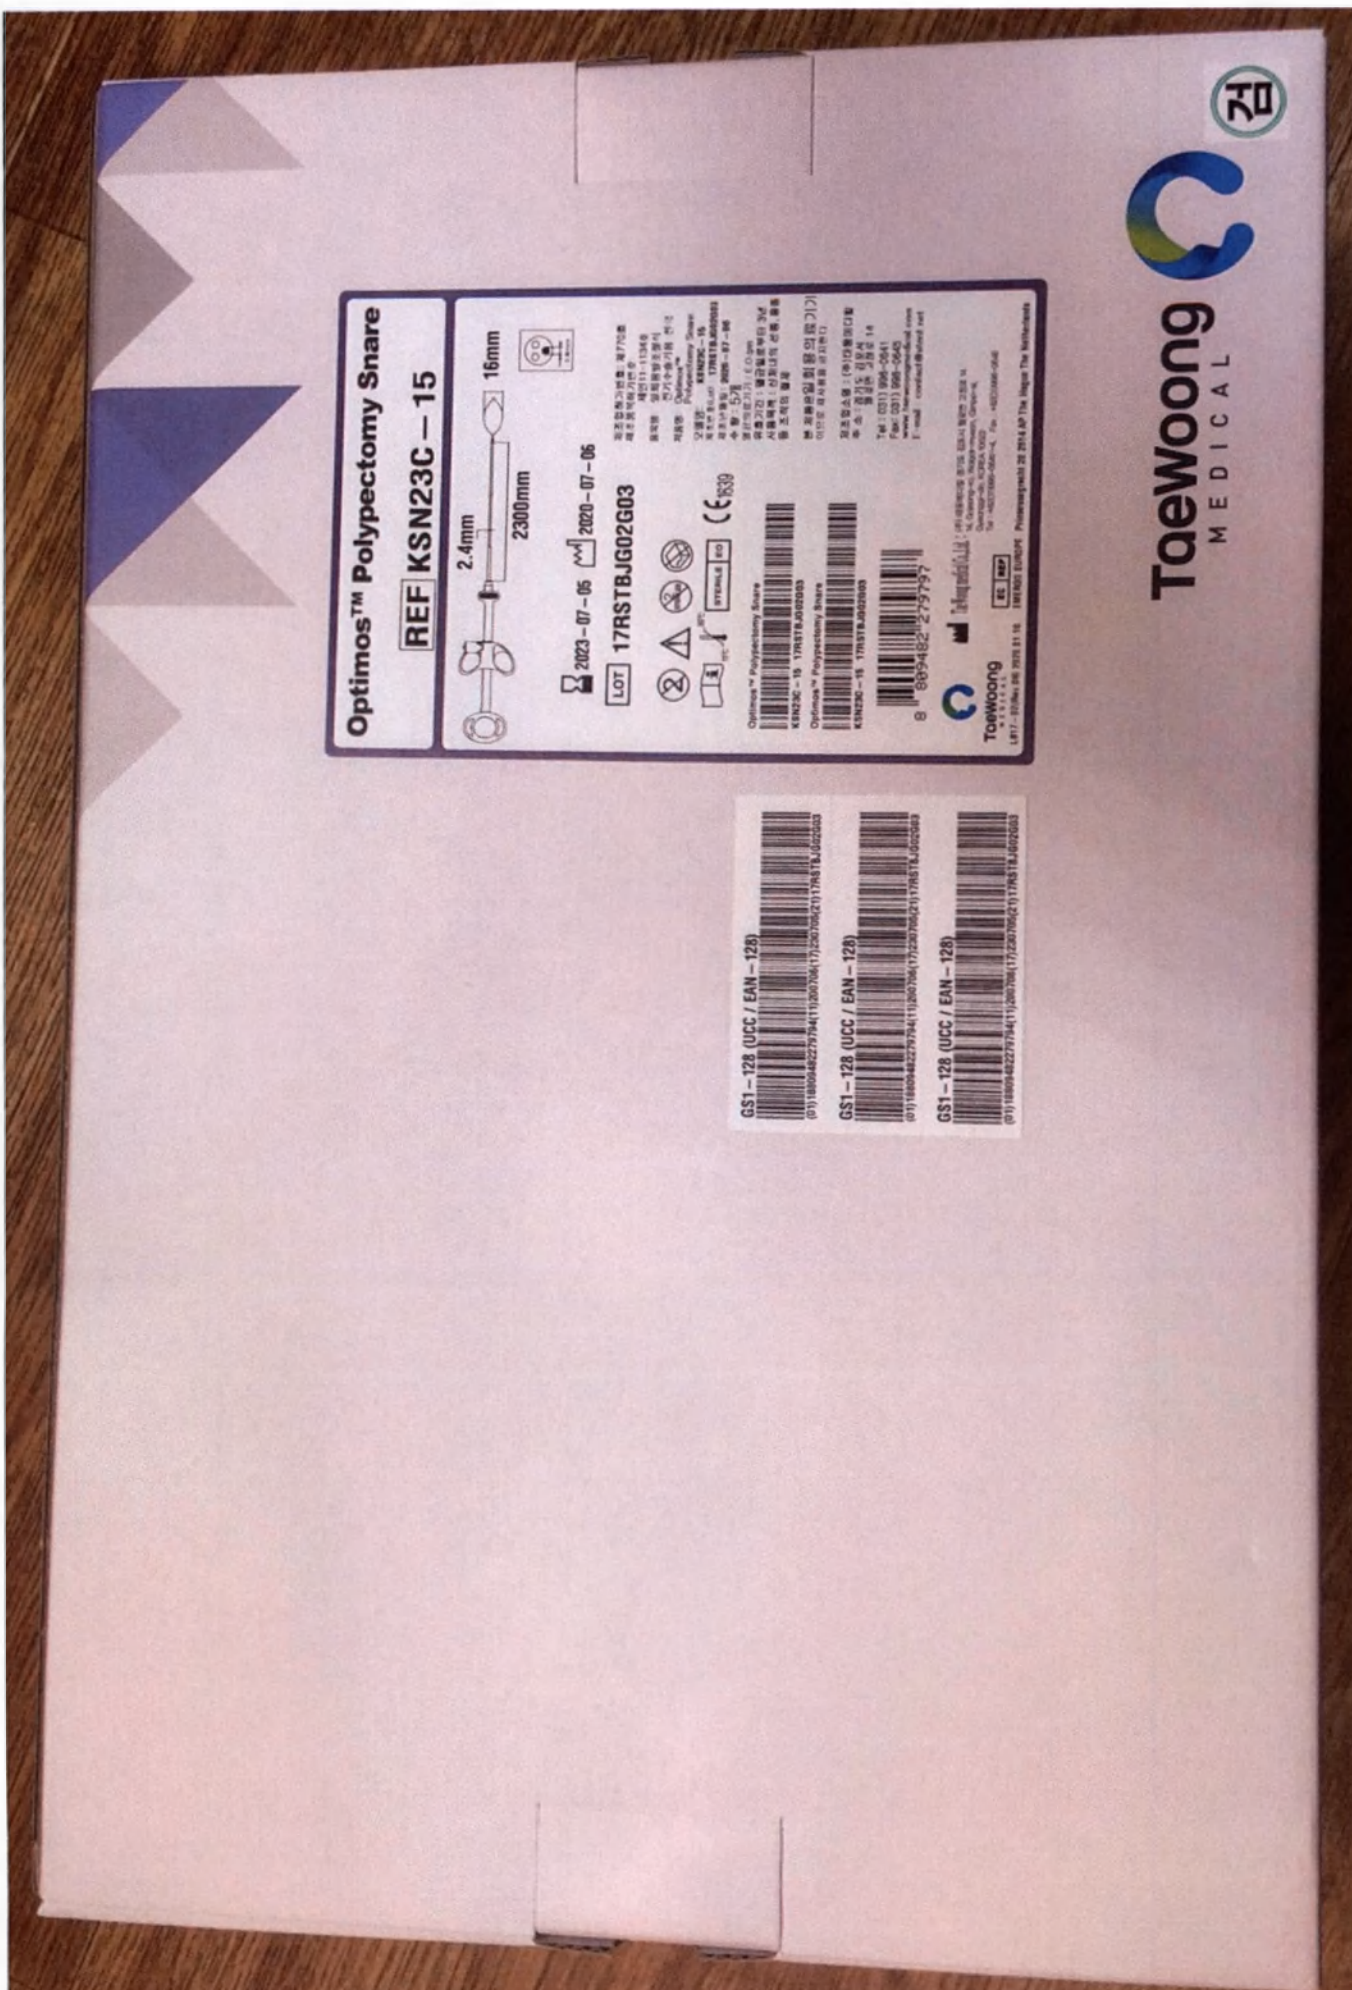

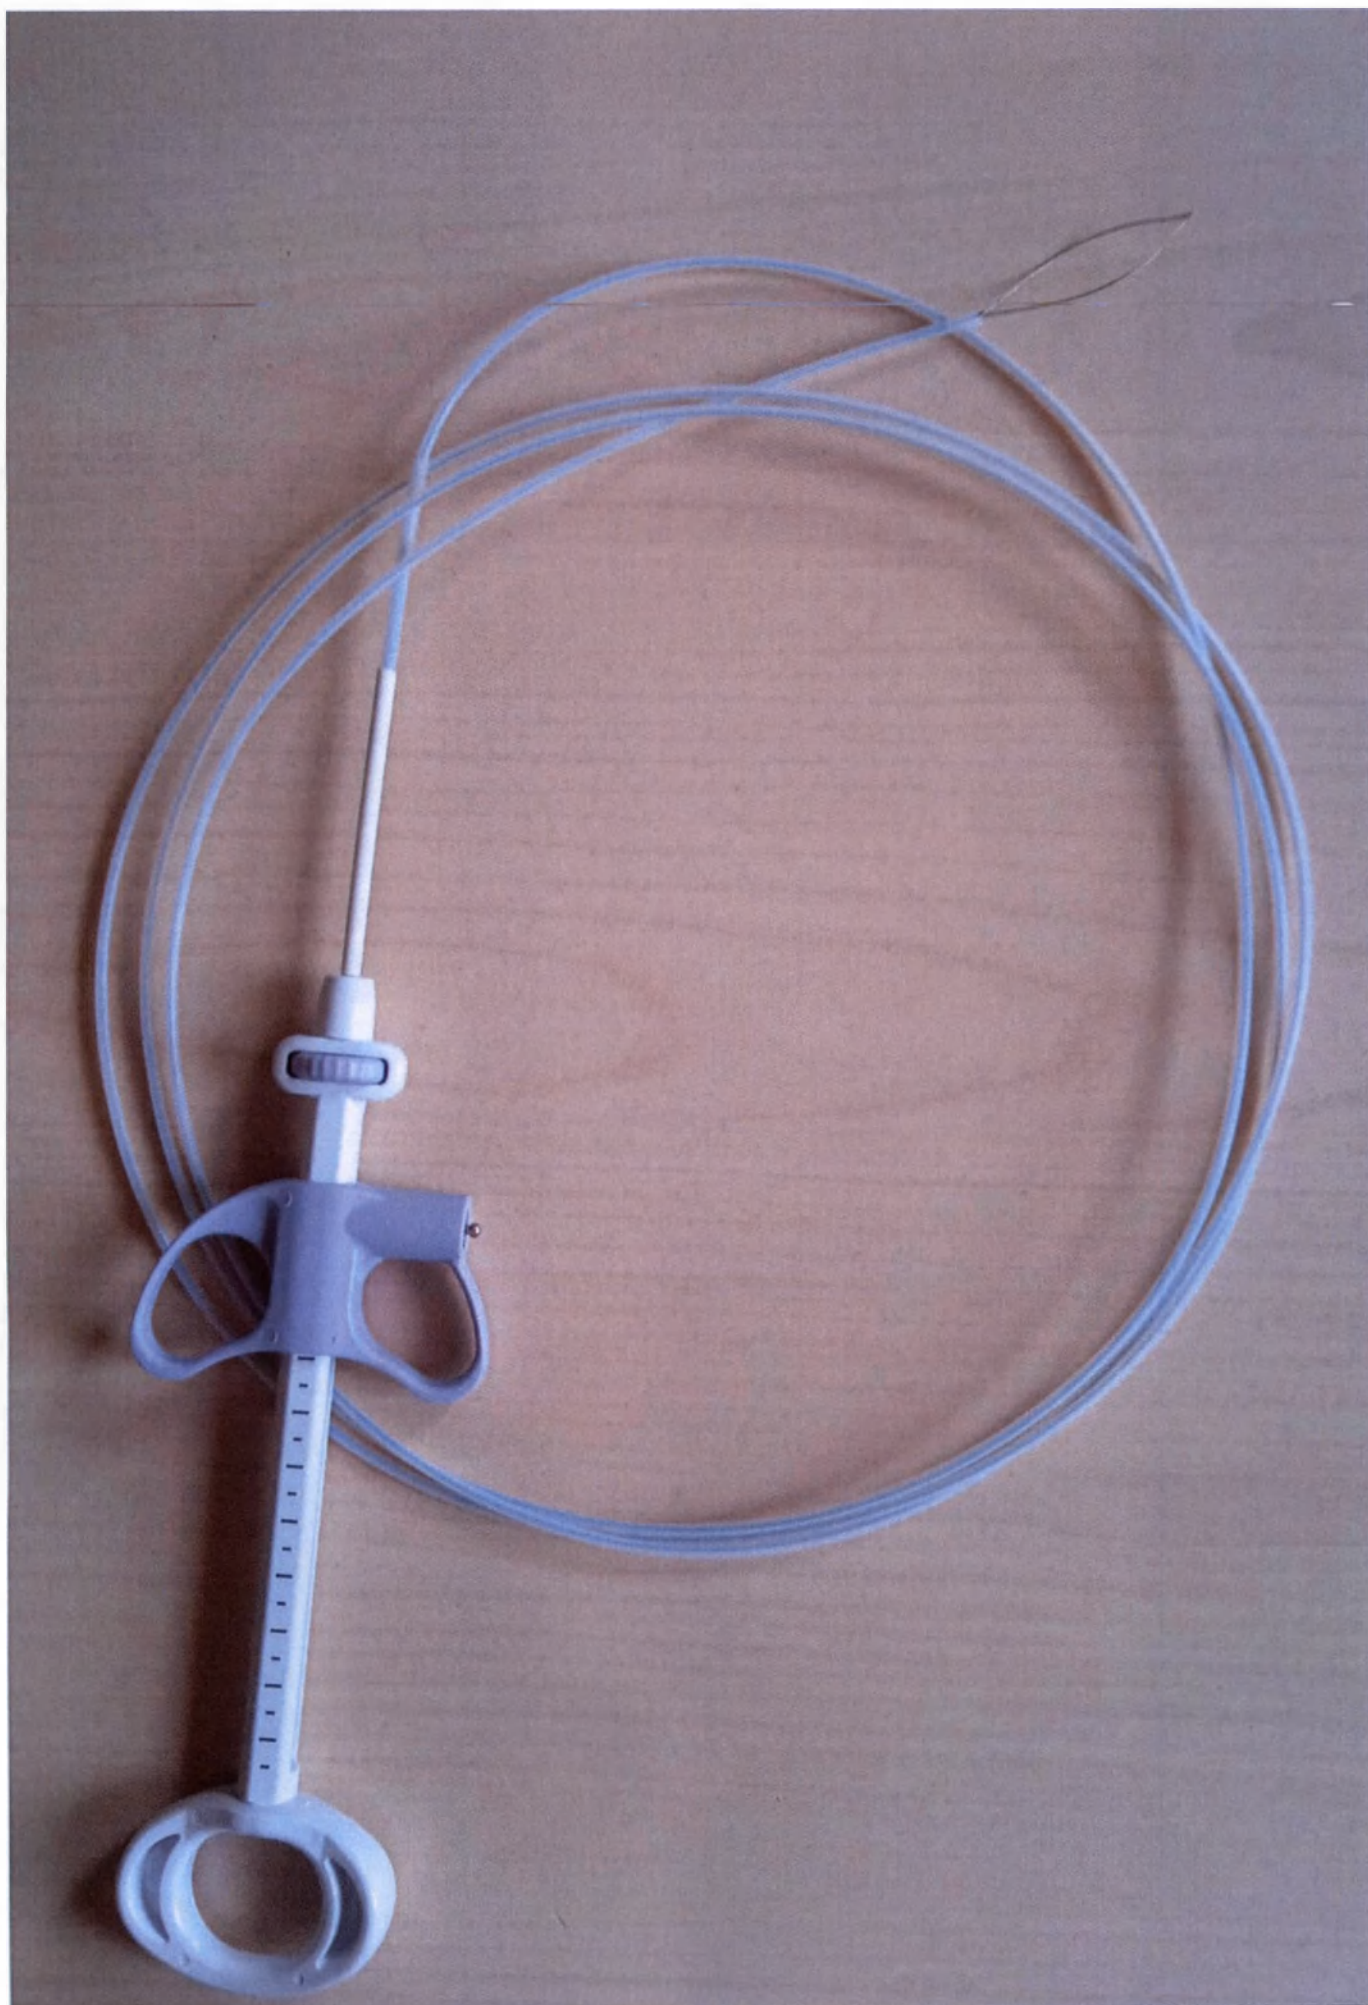

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-20 (в первичной упаковке)




2021/6/20 18:45

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-20 (во вторичной упаковке)




Optimos™ Polypectomy Snare

REF KSN23C-20



2023-07-05 2020-07-06

LOT 17RSTCJG02G03



Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03


Optimos™ Polypectomy Snare

KSN23C-20 17RSTCJG02G03

Taewoong
MEDICAL



Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-25

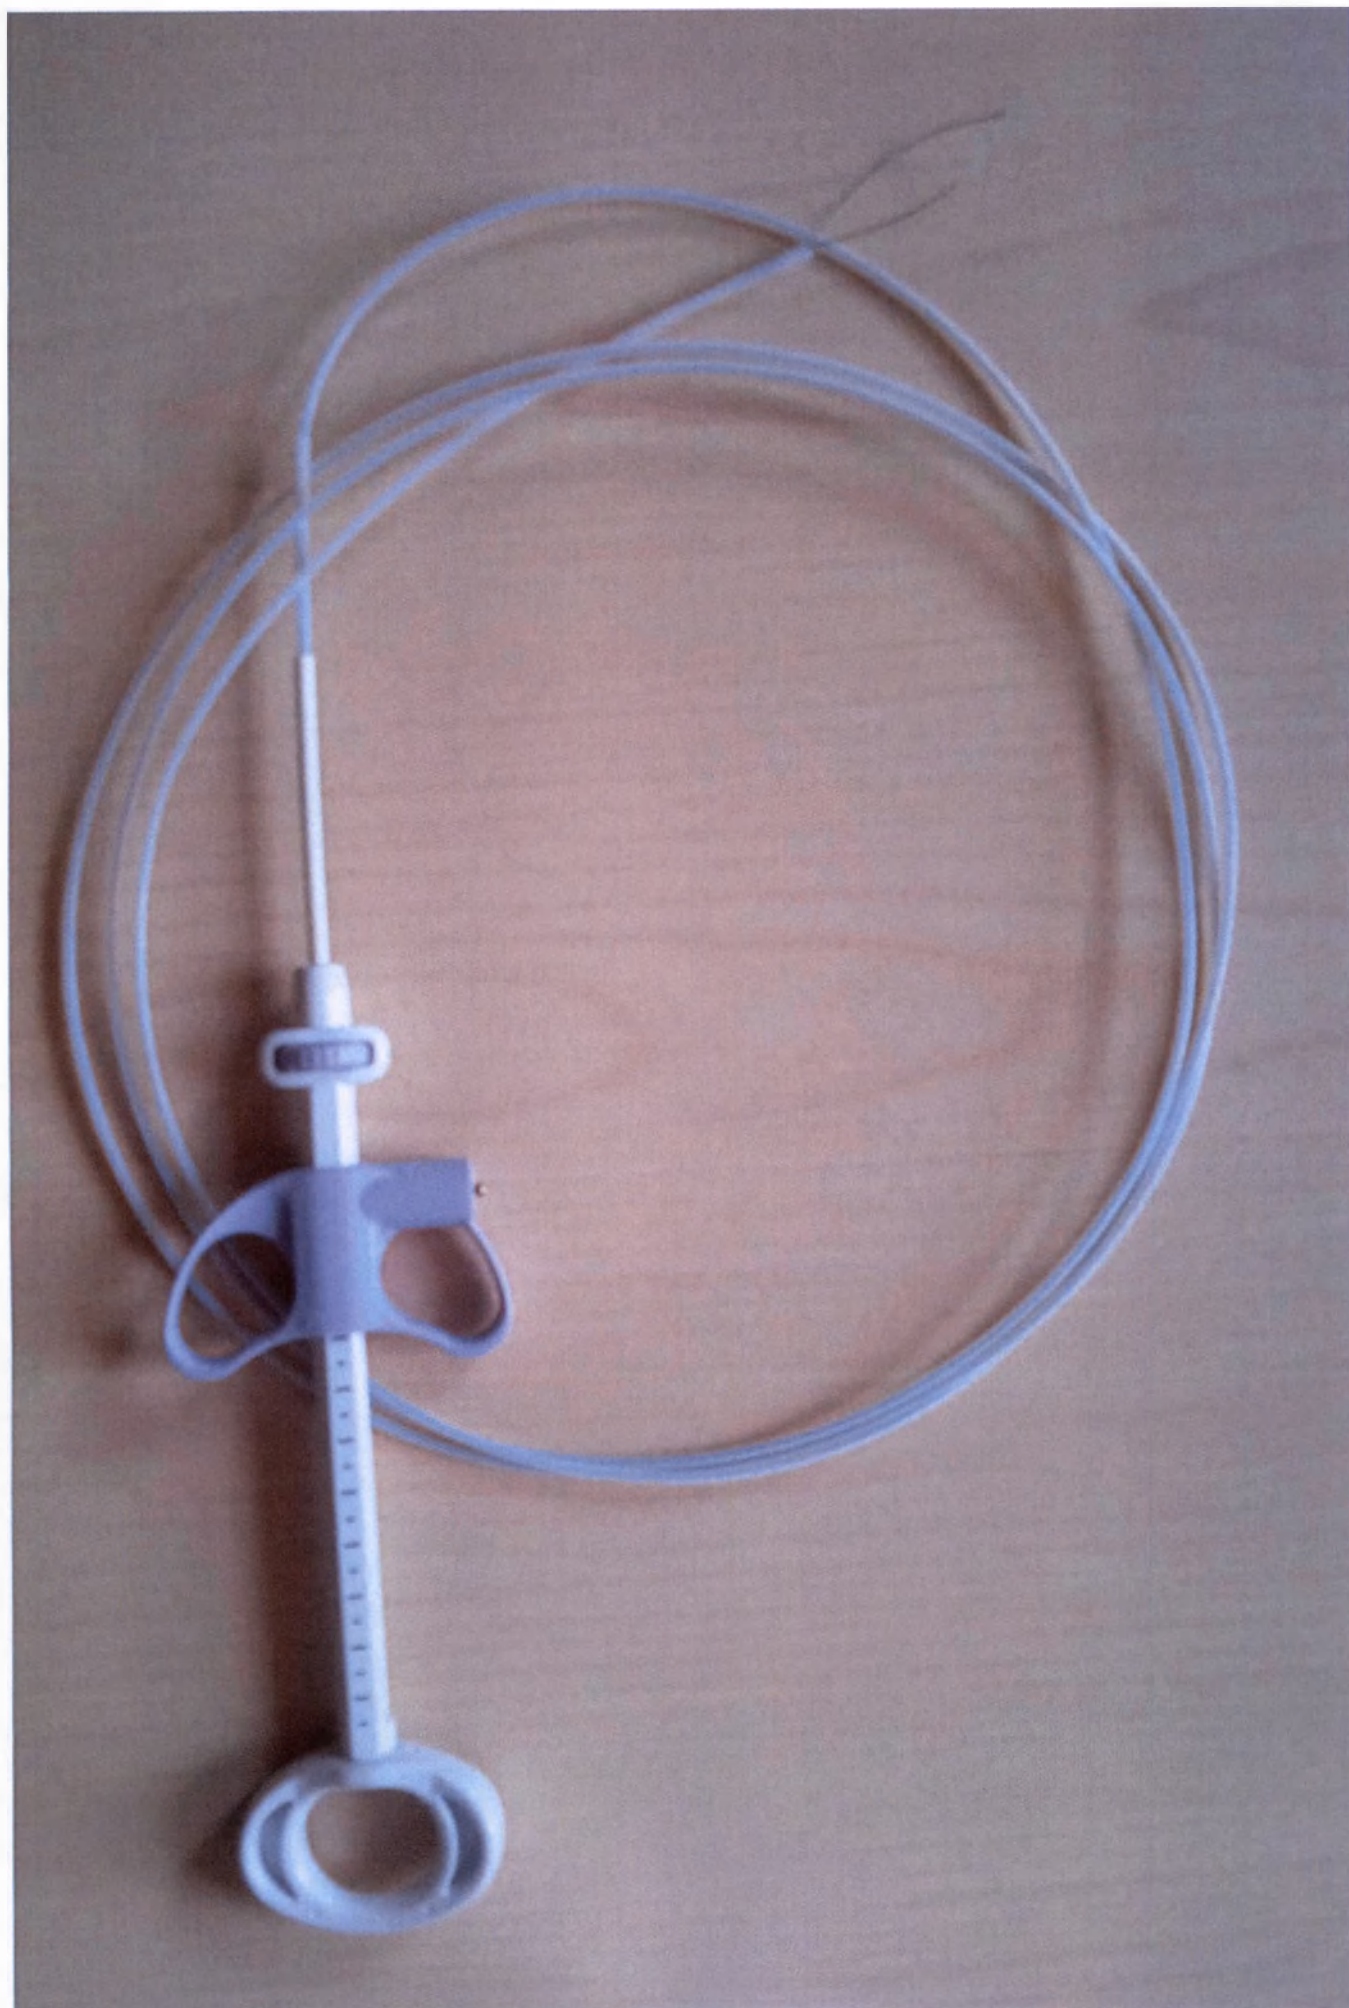

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-25(в первичной упаковке)

2021/6/20 18:48



Optimos™ Polypectomy Snare
REF KSN23C-25

2.4mm
 2300mm
 25mm

2023-07-05 2020-07-06

LOT 17RSTDJG02G03

STERILE ISO

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03

Optimos™ Polypectomy Snare
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03

8 889482 279629

TaeWoong
 MEDICAL
 1817-82 (Rev. 08) 2020.01.10

ISO 13485:2016
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03

최초입력자: 2020.07.06
 제조일자: 2020.07.06
 제품명: Polypectomy Snare
 제조사: KSN23C-25
 제조번호: 17RSTDJG02G03
 제조일자: 2020-07-06
 수량: 1개
 포장정보: 1개/박스
 사용기간: 3년/제조일자
 사용목적: 선조내시경, 선조
 용 조직의 제거

본 제품과 함께 제공되는 설명서
 의 내용을 꼭 읽어보십시오.

최초입력자: (주)태웅메디칼
 주소: 경기도 고양시 일산
 동구 일산 14
 Tel: (031) 999-0841
 Fax: (031) 999-0842
 www.taewoongmedical.com
 E-mail: contact@tmed.net

ISO 13485:2016
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03


ISO 13485:2016
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03

ISO 13485:2016
 KSN23C-25 17RSTDJG02G03

GS1-128 (UCC / EAN-128)

(01)08809482279629(11)200706(17)230705(21)17RSTDJG02G03

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-25 (во вторичной упаковке)

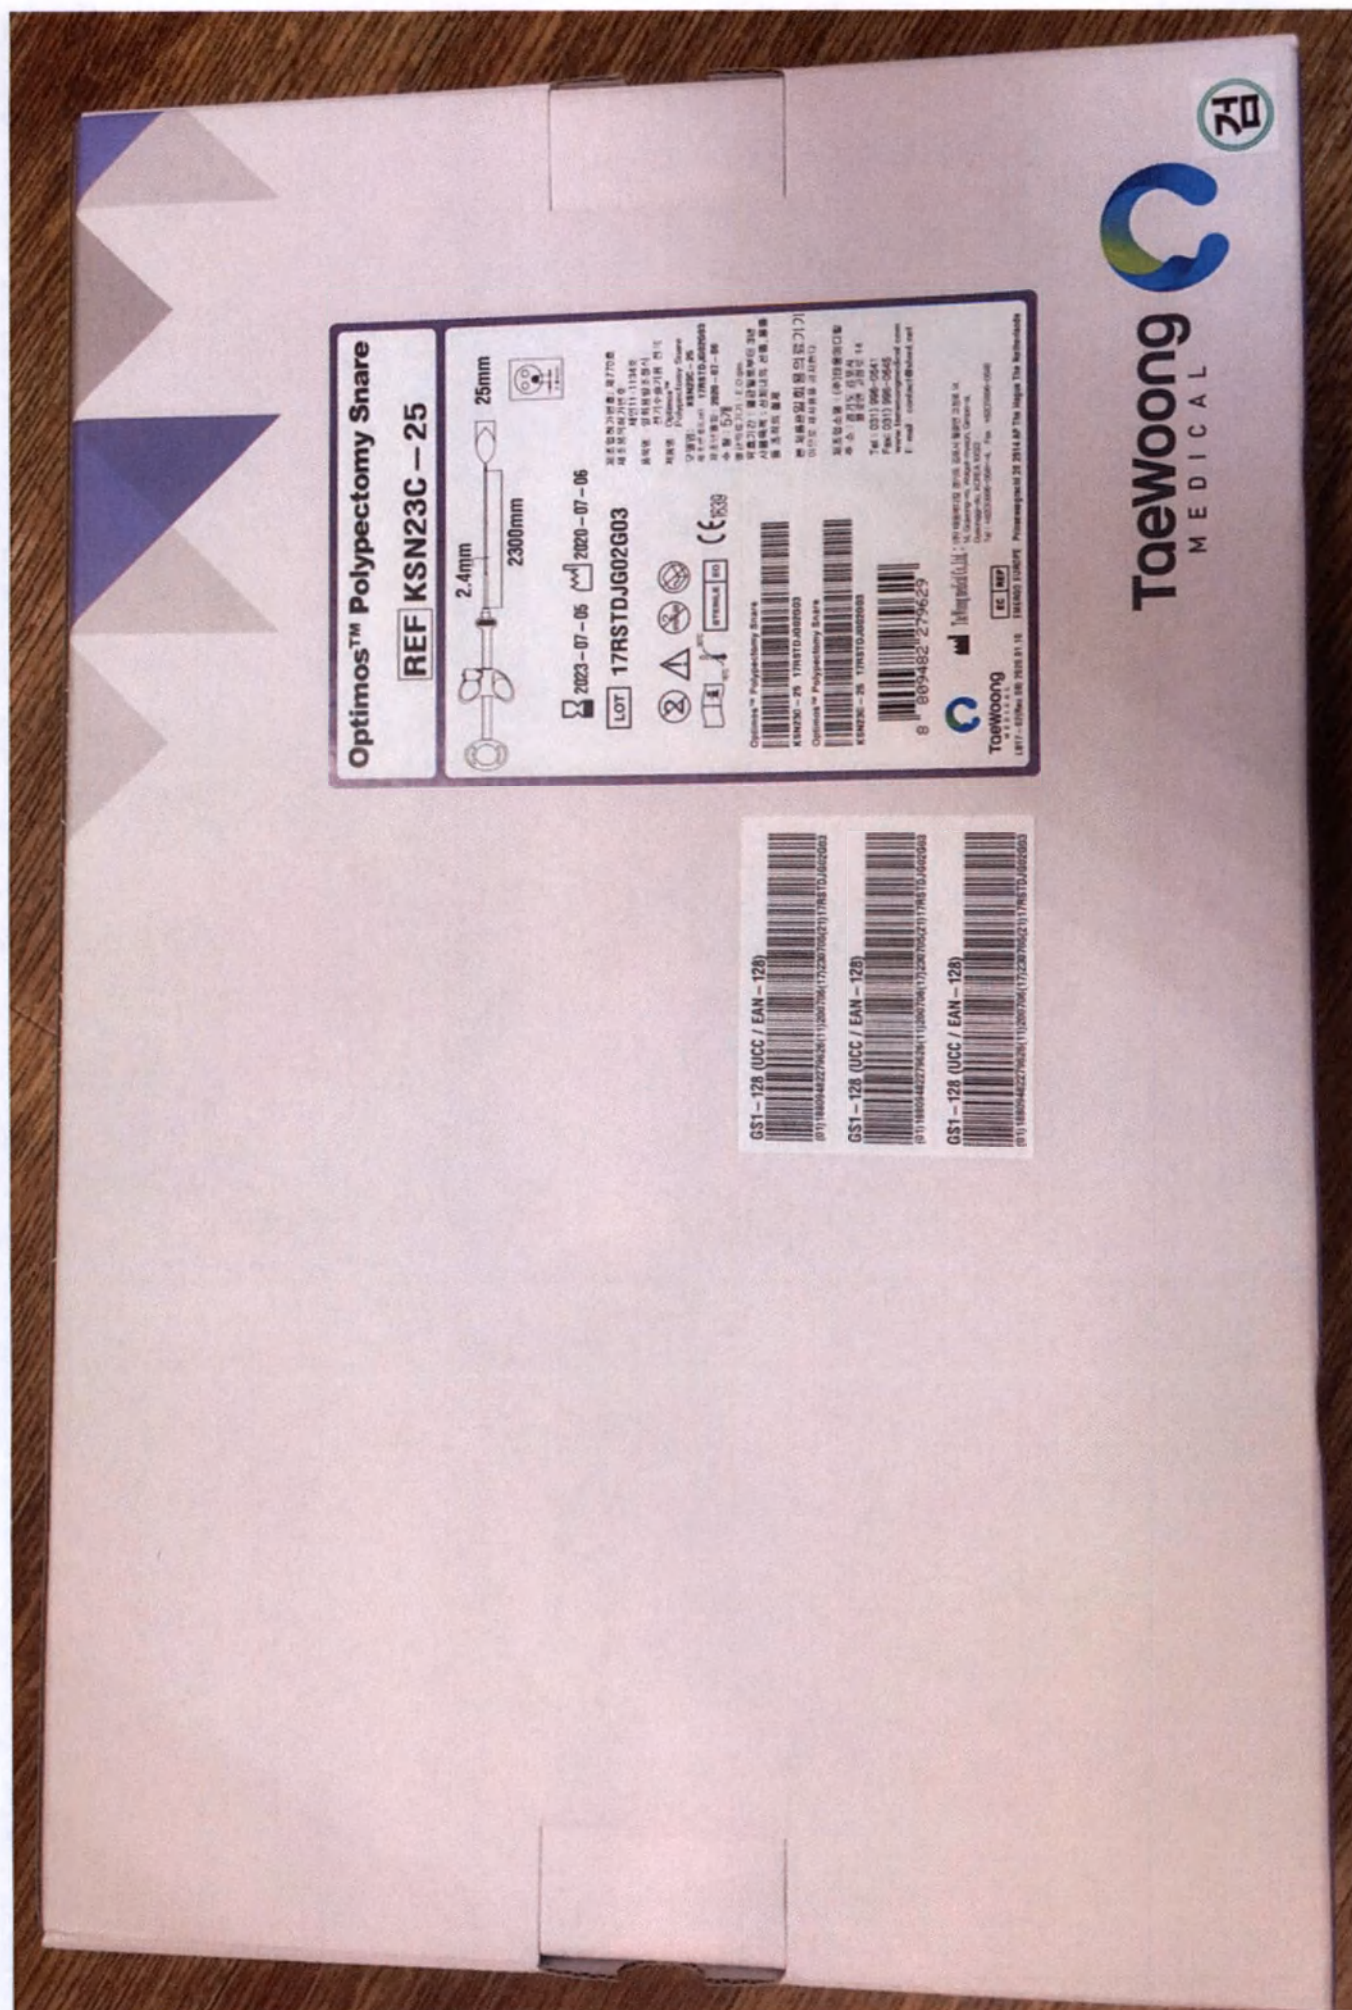

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-30



2021/6/20 18:51

Петля Optimos для полипэктомии, вращающаяся, тип «круглая», в комплекте с инструкцией по применению, вариант исполнения: KSN23C-30 (в первичной упаковке)





Генеральный директор

ООО «Ладмед»

Глебов Д.А.

Прочито и пронумеровано

177 лист 08

