



1. Плоскопанельный детектор SKR 4000, модель P-41 (Direct Digitizer SKR 4000, model P-41).
(вид спереди)

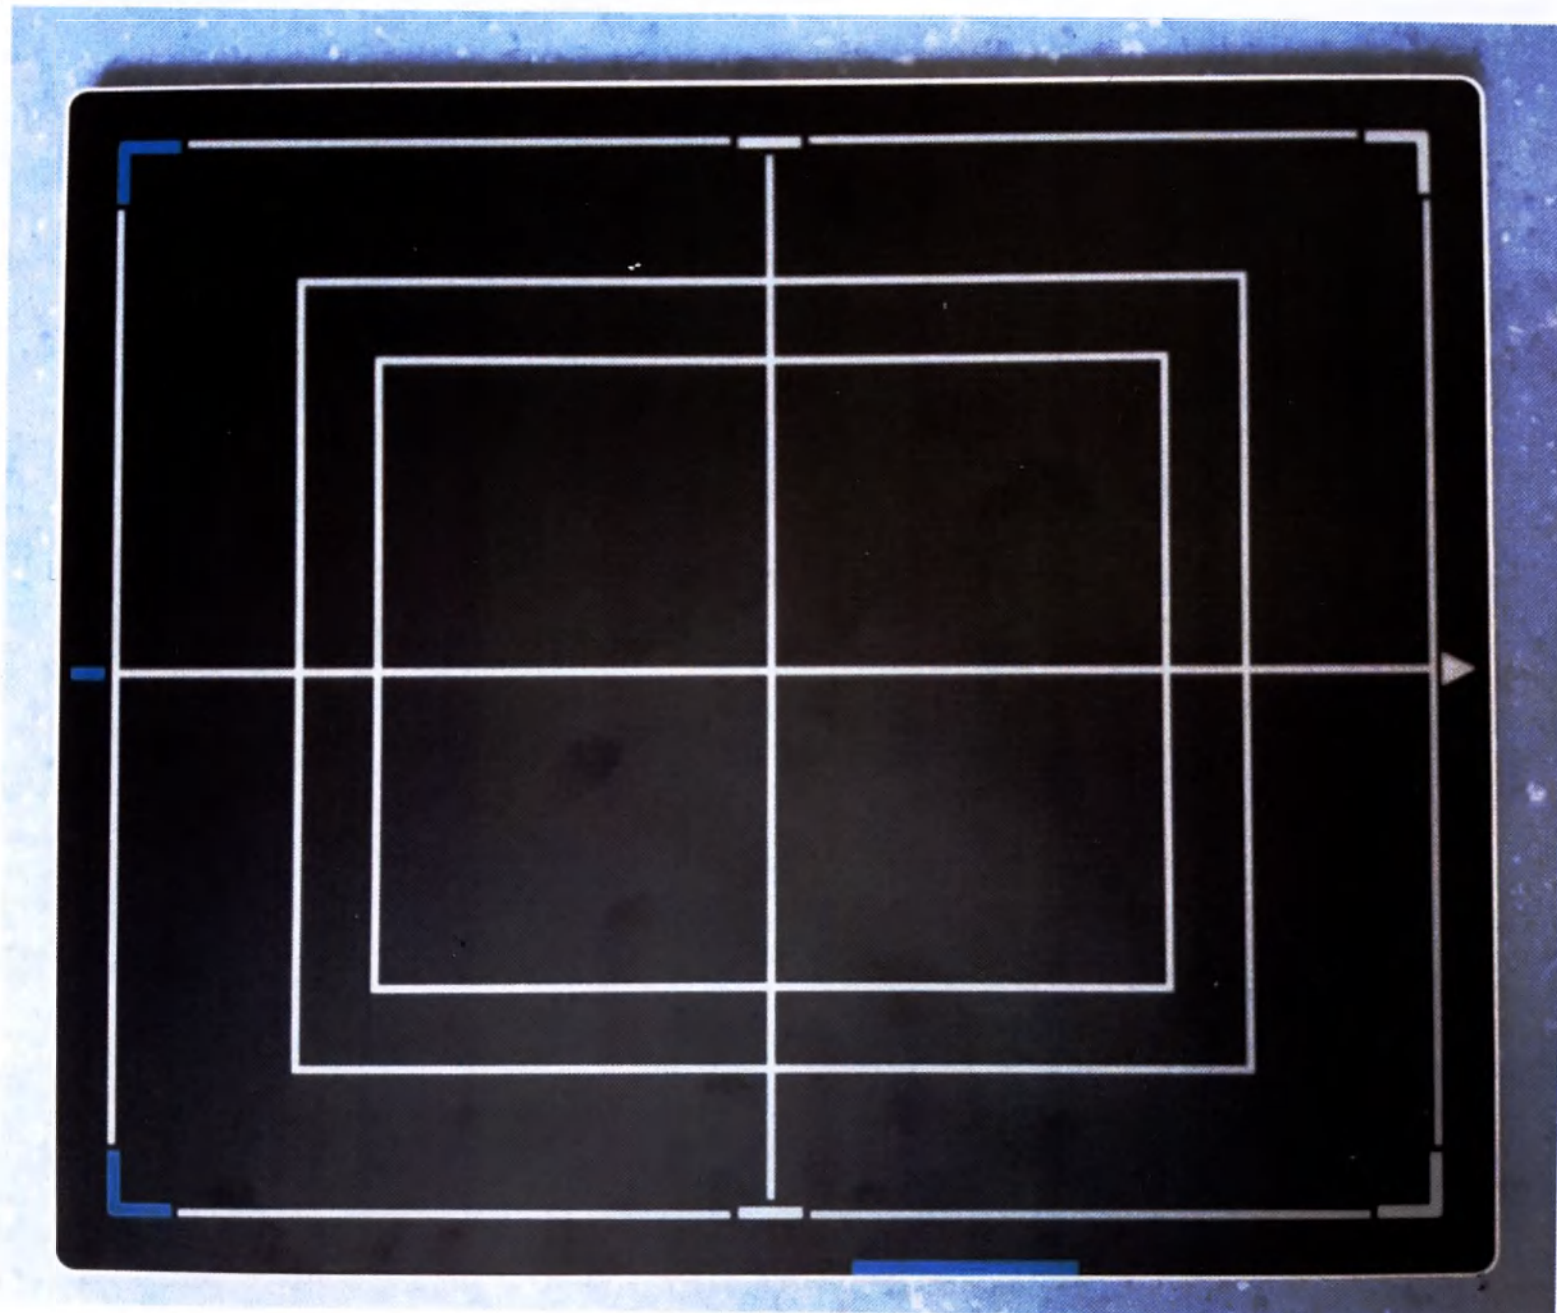

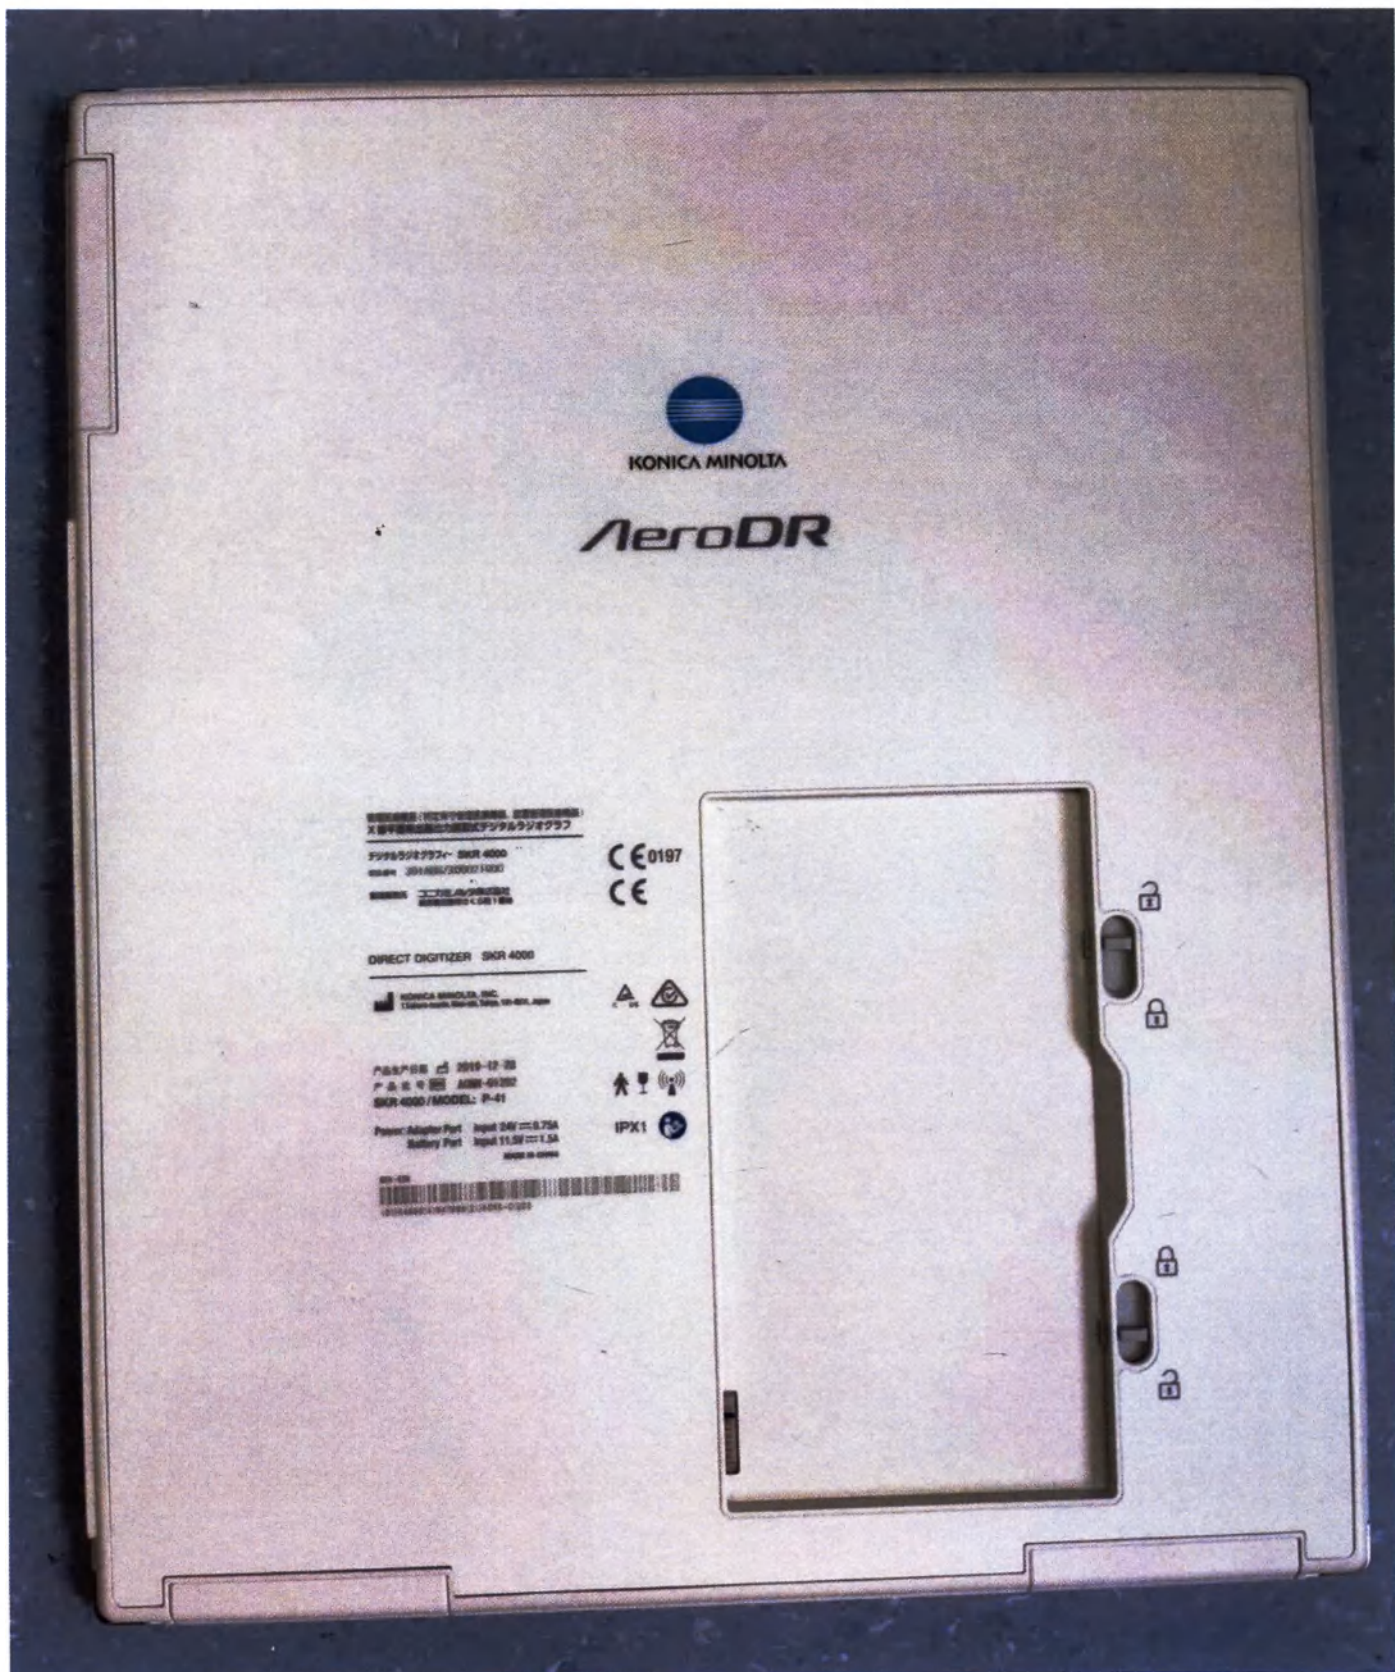

KONICA MINOLTA

AeroDR

直接式デジタル化装置
大画面直接式デジタル化装置

デジタル化装置 SKR 4000

型番 3014000/2000010000

型番 エアロDR 4000

DIRECT DIGITIZER SKR 4000

KONICA MINOLTA, INC.
1-10-1, Nishi-Shinjuku, Tokyo 163-8501, Japan

発売日 2010-12-30

型番 A000-04200

SKR 4000 / MODEL: P-41

Power Adapter Port Input 5W 5.75A
Battery Port Input 11.5W 1.5A
Made in China



CE 0197
CE



管理医療機器（特定保守管理医療機器、設置管理医療機器）
X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ

デジタルラジオグラフィ SKR 4000

認証番号 301ABBZX00021000

製造販売元 コニカミノルタ株式会社
東京都日野市さくら町1番地

CE 0197

CE

DIRECT DIGITIZER SKR 4000



KONICA MINOLTA, INC.
1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan



产品生产日期 2019-12-28

产品批号 SN ACNN-01202

SKR 4000 / MODEL: P-41



Power: Adapter Port Input 24V $\approx$ 0.75A
Battery Port Input 11.5V $\approx$ 1.5A

IPX1



MADE IN CHINA

GSI-12B



(01)04360141847986(21)ACNN-01202



KONICA MINOLTA

AeroDR

**DIRECT DIGITIZER
SKR 4000**

**Руководство по
эксплуатации**

CE 0197



Manufacturer:
KONICA MINOLTA, INC.
1 Sakuramachi, Hino-shi, Tokyo 191-8511, Japan

RU

02



KONICA MINOLTA

ImagePilot

ImagePilot

Version 1.91

Руководство по
эксплуатации

CE 0197



Manufacturer:

KONICA MINOLTA, INC.

1 Sakura-machi, Hino-shi, Tokyo, 191-8511, Japan

RU

08



可充式锂离子电池组



产品型号: BATTERY-KV
额定电压: 10.8V
充电限制电压: 12.6V
额定容量: 4125mAh/44.55Wh
典型容量: 4180mAh/45.14Wh
执行标准: GB31241-2014
识别码: 3ICP6/65/80



上海奕瑞光电科技股份有限公司
上海市浦东新区
瑞庆路590号9幢2层202室 2019-46



警告!

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用,以防性能失效;
- 若出现严重鼓胀,请勿继续使用;
请勿置于高温环境中;
- 电池浸水后禁止使用!
- 请使用iRay指定充电器为电池充电,
请勿使用其它型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时,请及时给电池充电;
- 请用同型号电池替代,使用不同型号电池
有燃烧或者爆炸危险;
- 请将电池放置在儿童无法触及的地方;
- 请根据当地法律处理废旧电池。

Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model: BATTERY-KV
Rated Voltage: 10.8V
Limited Charging Voltage: 12.6V
Rated Capacity: 4125mAh/44.55Wh
Typical Capacity: 4180mAh/45.14Wh
Standard: GB31241-2014
Identification code: 3ICP6/65/80



iRay Technology Co., Ltd.
Rm. 202, Building 7, No. 590, Ruiqing Rd.,
Zhangjiang East, Pudong, Shanghai, China 2019-46
www.iraygroup.com



iRay Europe GmbH
In den Dorfriesen 14, 71720 Oberstenfeld Germany

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use,
Please do not put battery in high temperature environment.
- Please use the charger designated by iRay to charge the battery.
Please do not use chargers of any other specifications;
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less
than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries
may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.

Avertissement!

- Ne pas démonter, frapper, compresser la batterie ou mettre au feu;
- La sur-décharge va dégrader les performances de la batterie;
- En cas de gonflement, ne plus utiliser la batterie, ne pas laisser la batterie
dans un environnement très chaud;
- Utiliser le charger spécifié par iRay pour charger la batterie.
N'utilisez pas d'autres modèles de chargeurs;
- Charger la batterie pleinement lors de la première utilisation;
- Charger la batterie immédiatement lorsque la batterie est moins de 5%;
- Remplacer la batterie avec le même modèle, sinon la batterie peut
exploser ou brûler;
- Mettre la batterie hors de la portée de l'enfant;
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux lois locales.



B07205194699991688



Li-ion

IS 16046/IEC 62133



R-XXXXXXXXX
www.bis.gov.in

P+ P40CTMCPA















Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 13
(тринадцати) листах

Генеральный директор
ООО «Кошика Минолта Медикал
Системс Руссиа» Суборов А.А.
[Signature]