

Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»



Денисенко Е. А.
2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur

2024

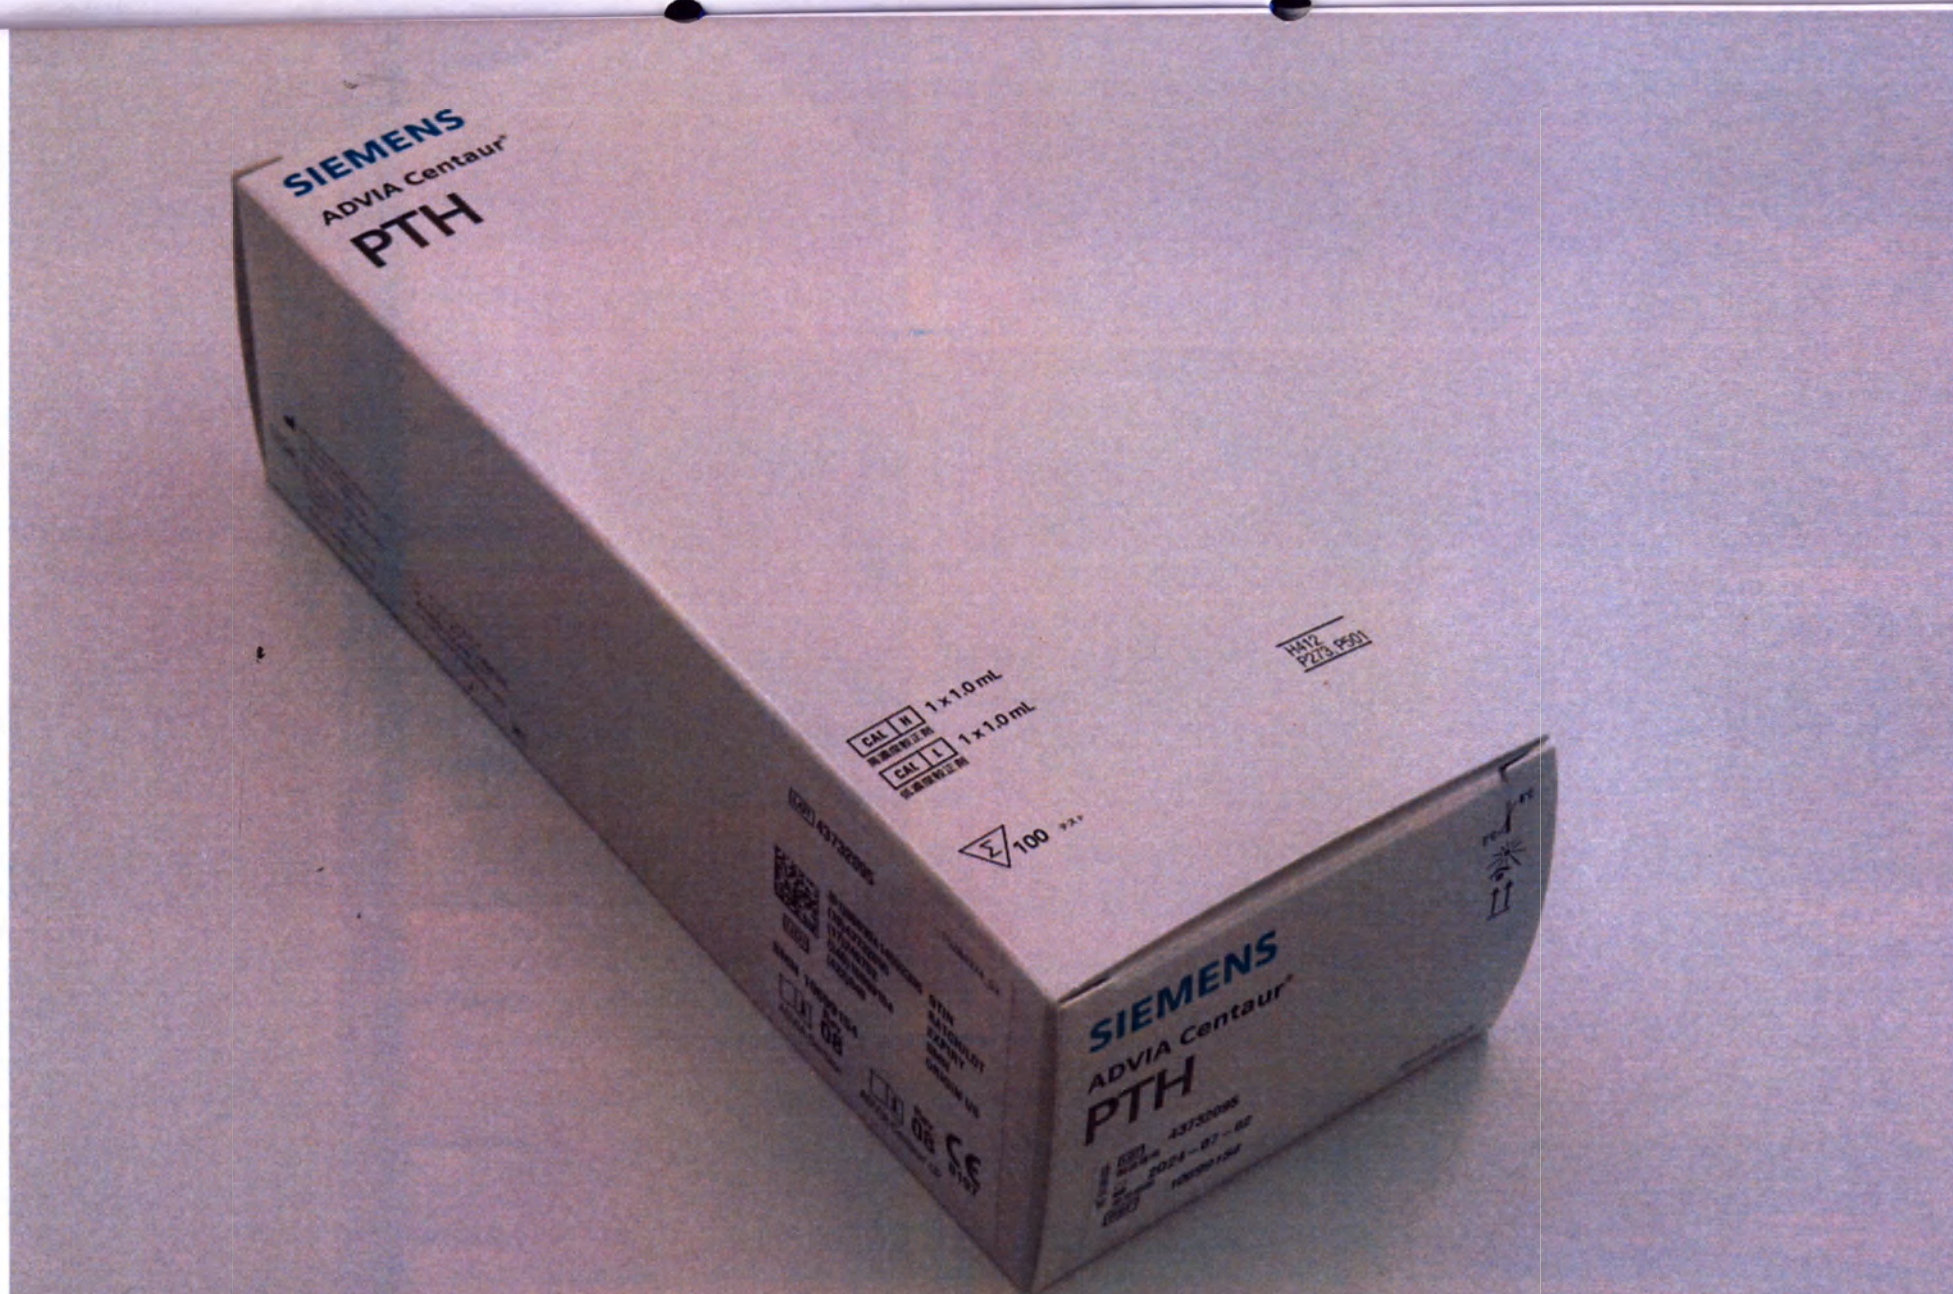


Рисунок 1 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 100 тестов) (общий вид фото 1)

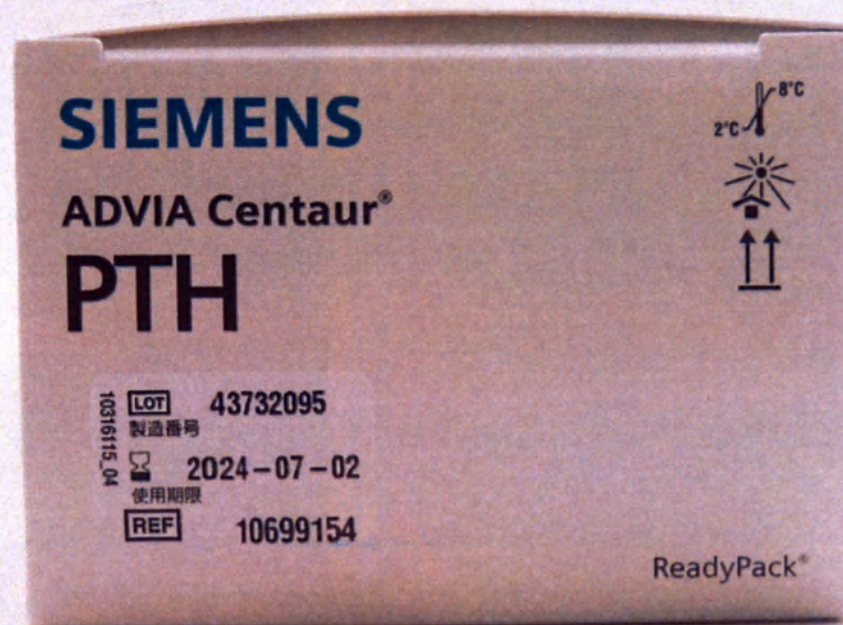


Рисунок 2 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 100 тестов) (общий вид фото 2)

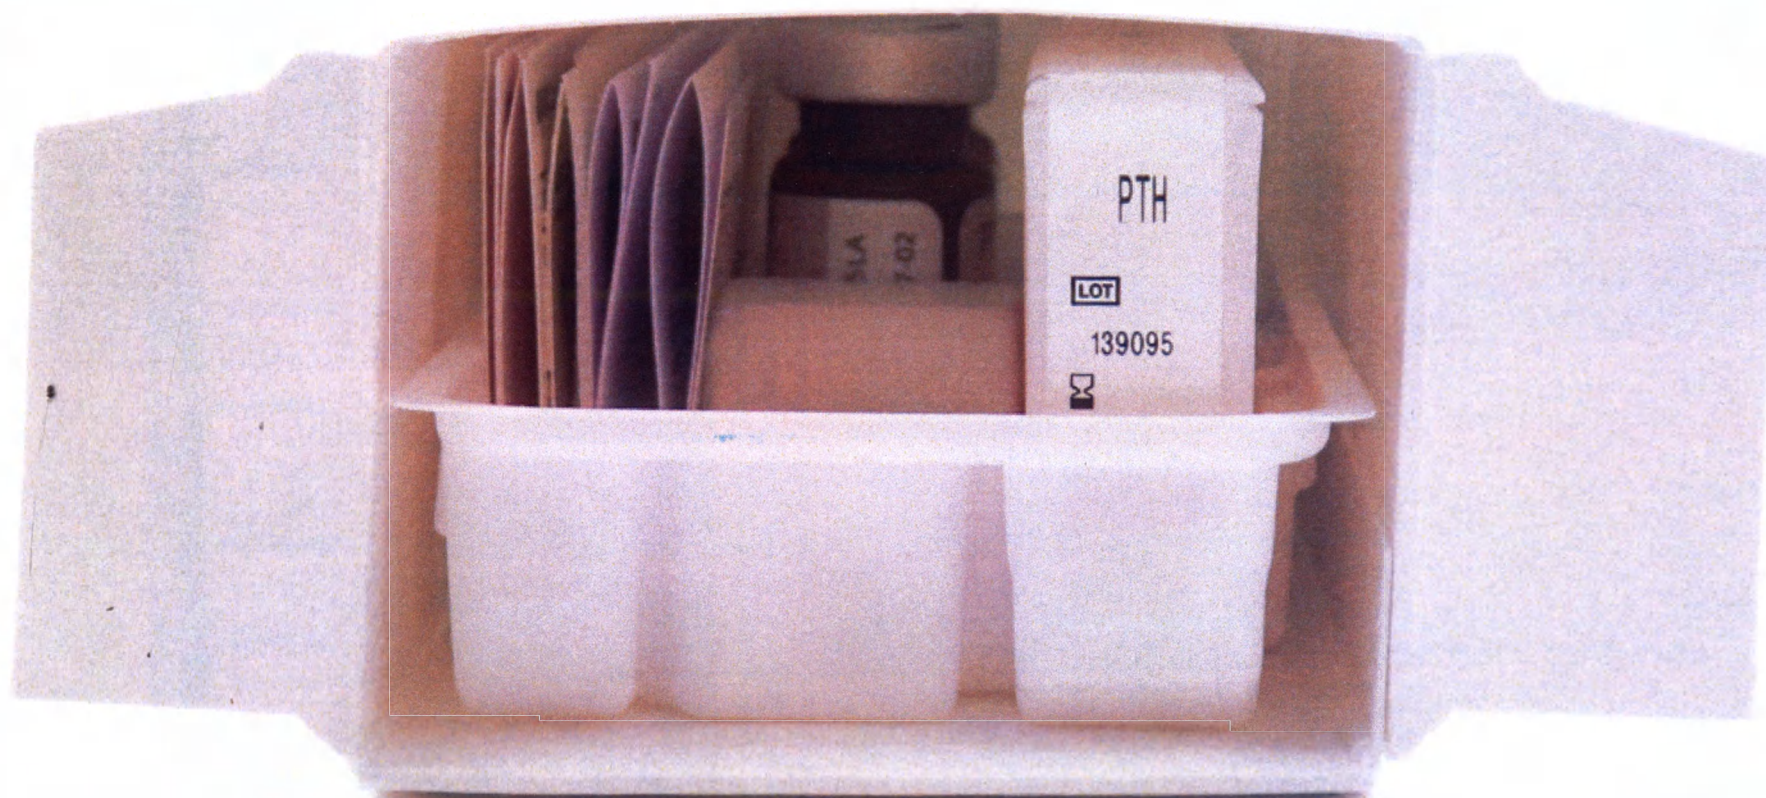


Рисунок 3 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 100 тестов) (общий вид фото 3)

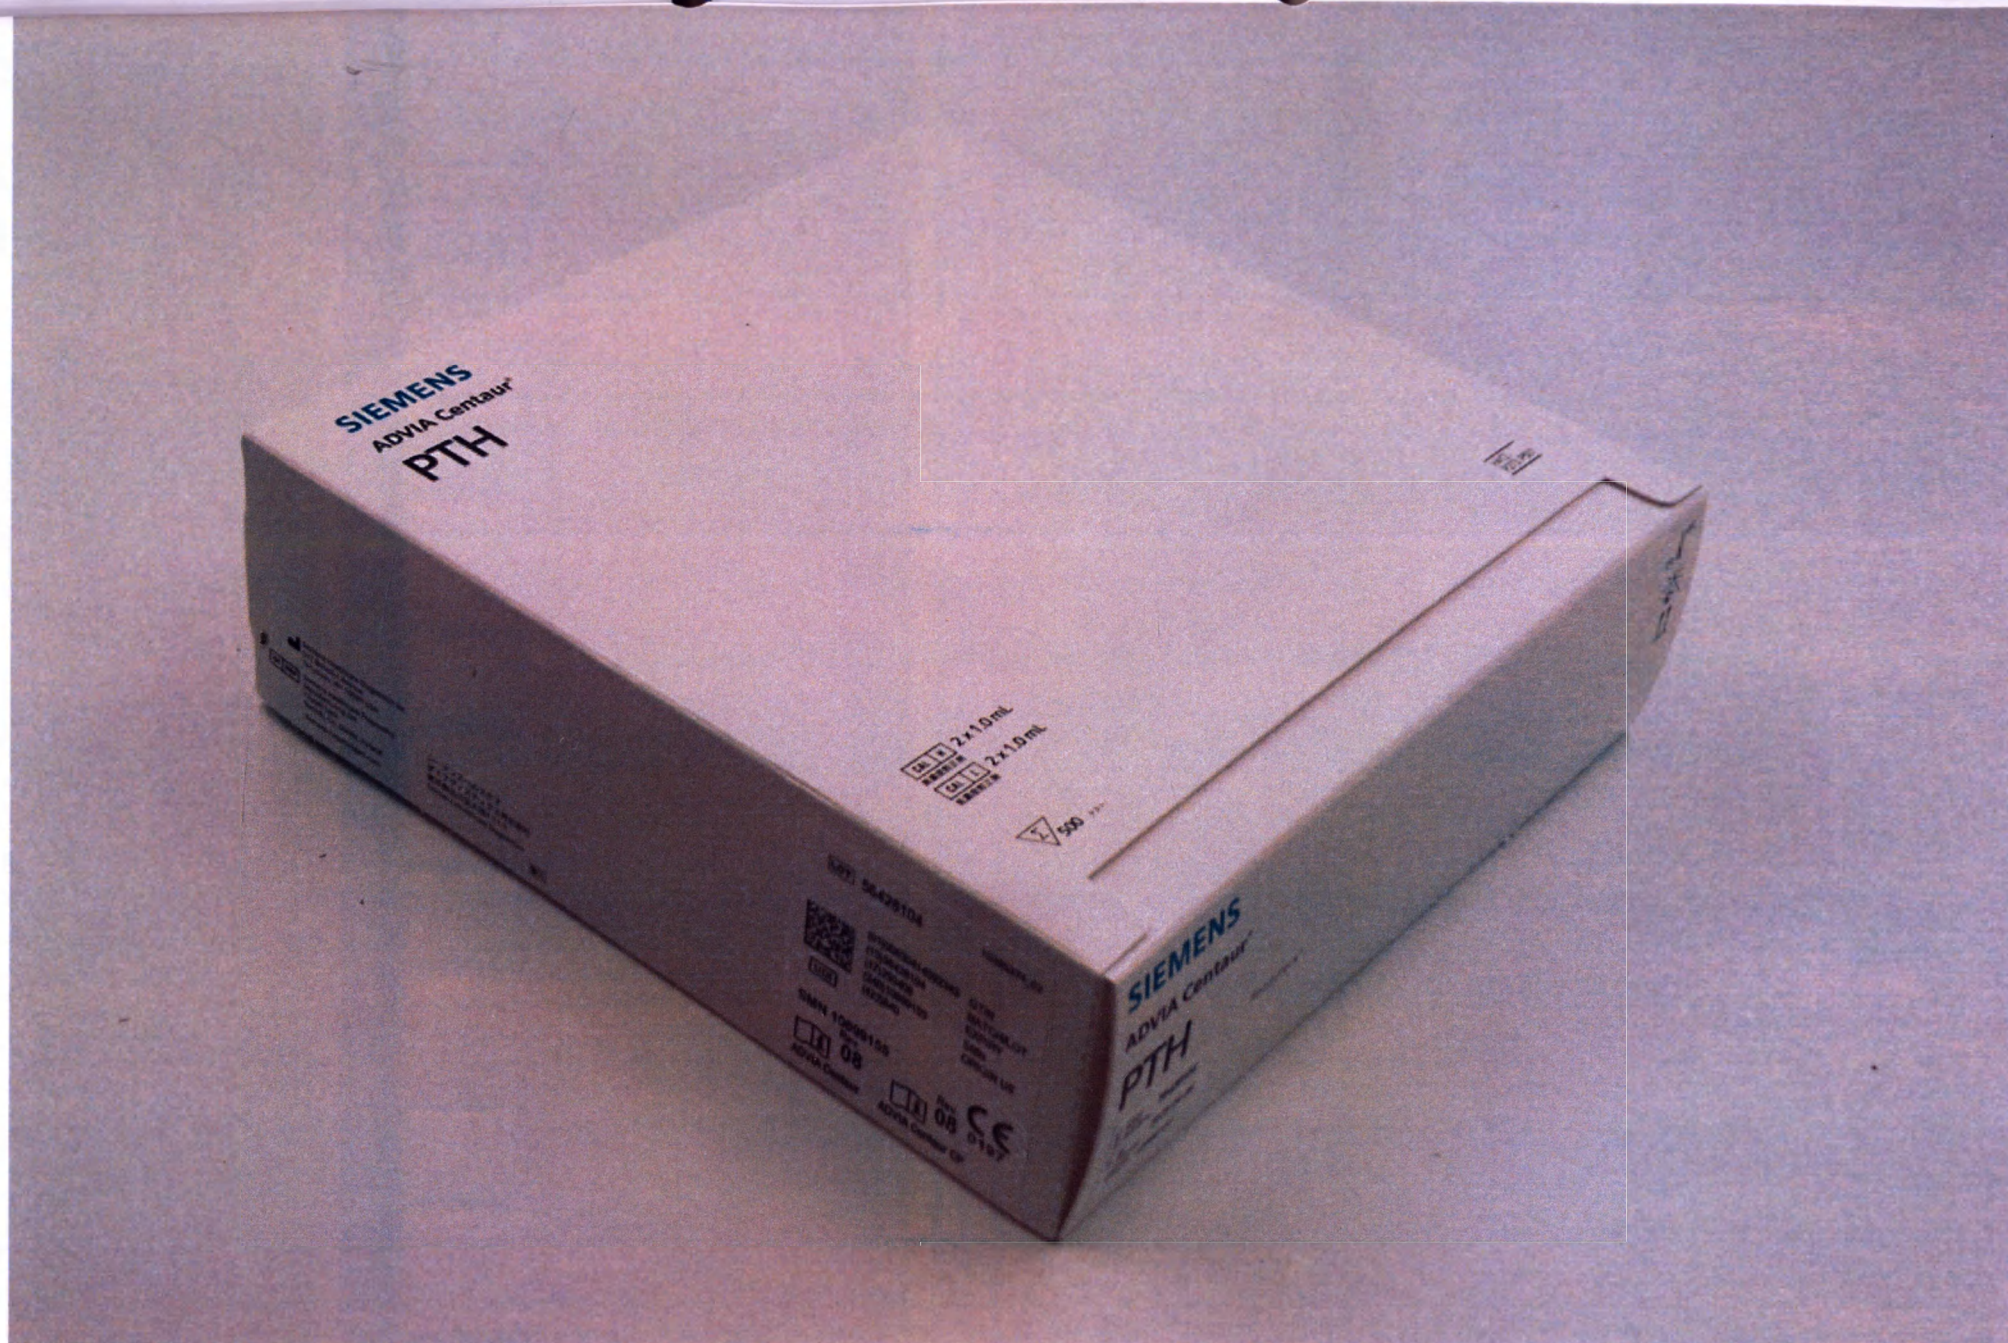


Рисунок 4 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 1)

SIEMENS

ADVIA Centaur®

PTH

ReadyPack®

LOT 56428104

製造番号

2025-04-08

使用期限

REF 10699155



Рисунок 5 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 2)

SIEMENS

ADVIA Centaur®

PTH

ReadyPack®

Σ 500

CAL	H	2 x 1.0 mL
-----	---	------------

高濃度校正剤

CAL	L	2 x 1.0 mL
-----	---	------------

低濃度校正剤



IVD 体外診断用医薬品

siemens-healthineers.com/eifu

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of intact parathyroid hormone (PTH) in human serum and plasma using the ADVIA Centaur® systems.

Contains: PTH Solid Phase [biotinylated mouse monoclonal anti-human PTH antibody bound to streptavidin-coated paramagnetic particles (~0.4 g/L) in buffered saline with bovine gamma globulin • bovine serum albumin • preservatives]; PTH Lite Reagent [acridinium ester-labeled mouse monoclonal anti-human PTH antibody (~0.6 mg/L) in buffered saline with mouse gamma globulin • bovine serum albumin • preservatives]; PTH Calibrator [intact PTH synthetic peptide in buffered saline with human EDTA plasma (10%) • surfactants • preservatives].

Рисунок 6 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 3)



Рисунок 7 Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur (Фасовка 500 тестов) (общий вид фото 4)

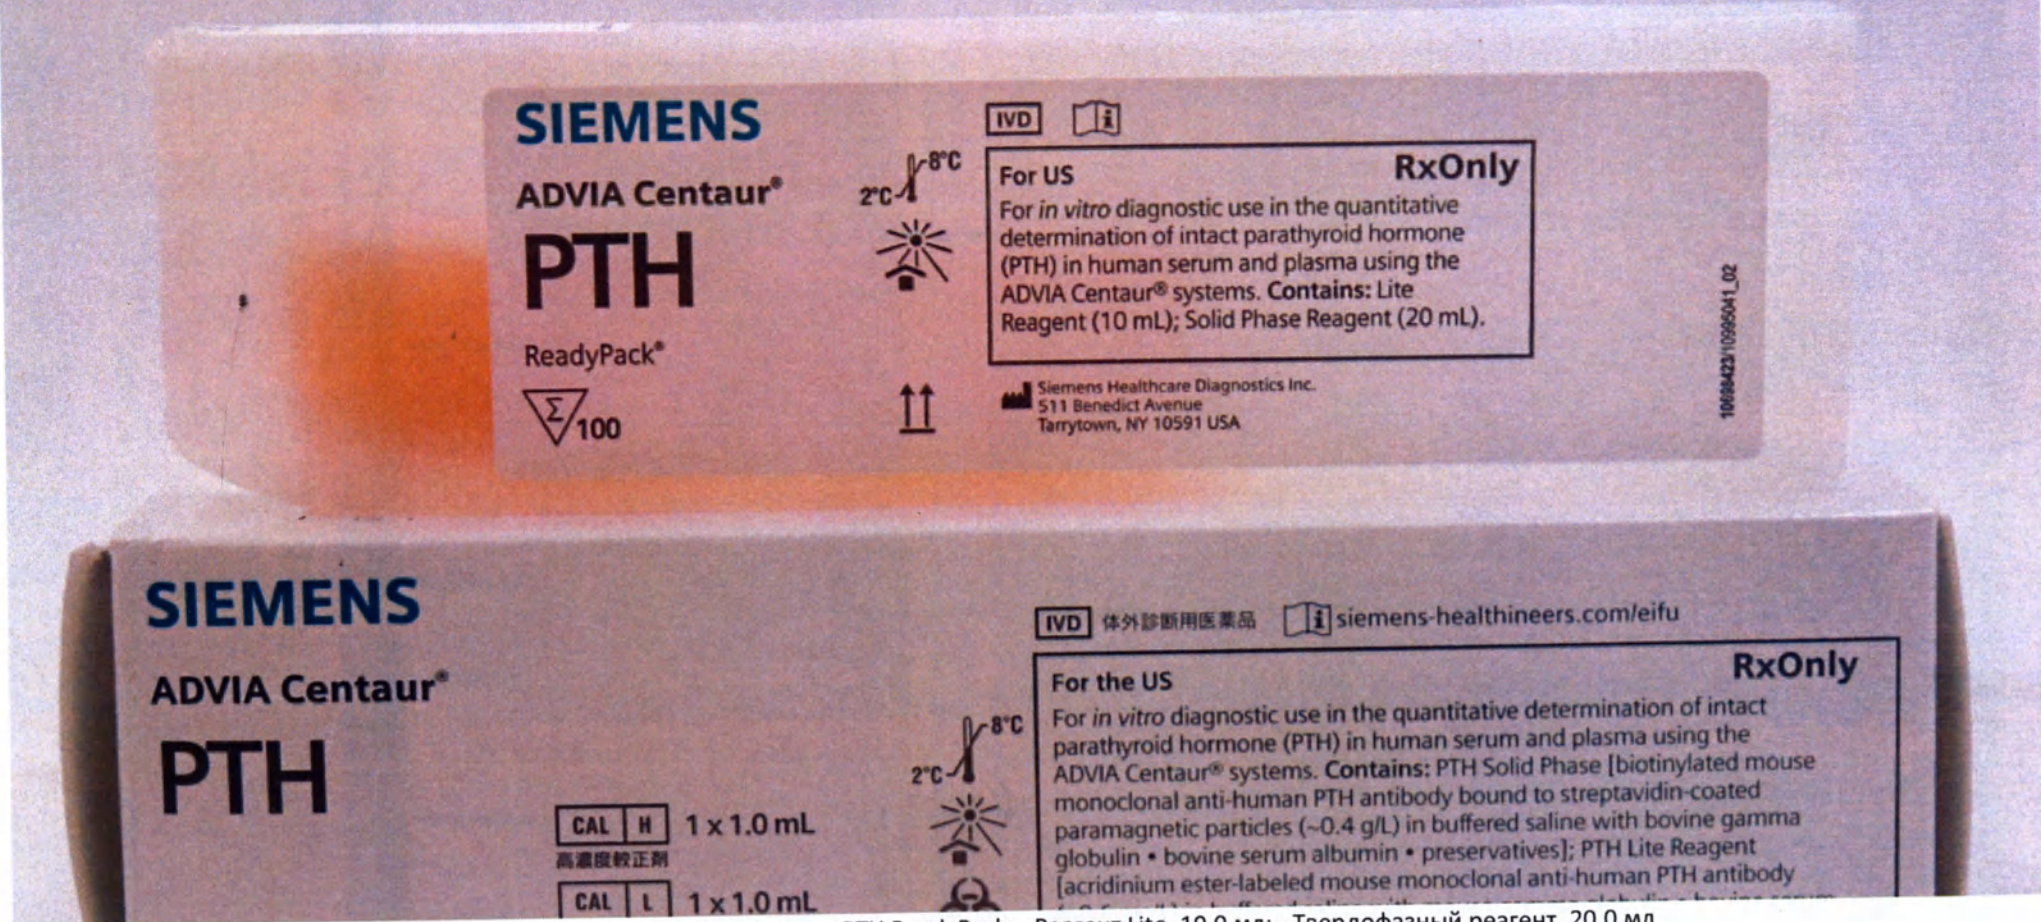


Рисунок 8 Основные реагенты ADVIA Centaur PTH ReadyPack: - Реагент Lite, 10,0 мл; - Твердофазный реагент, 20,0 мл

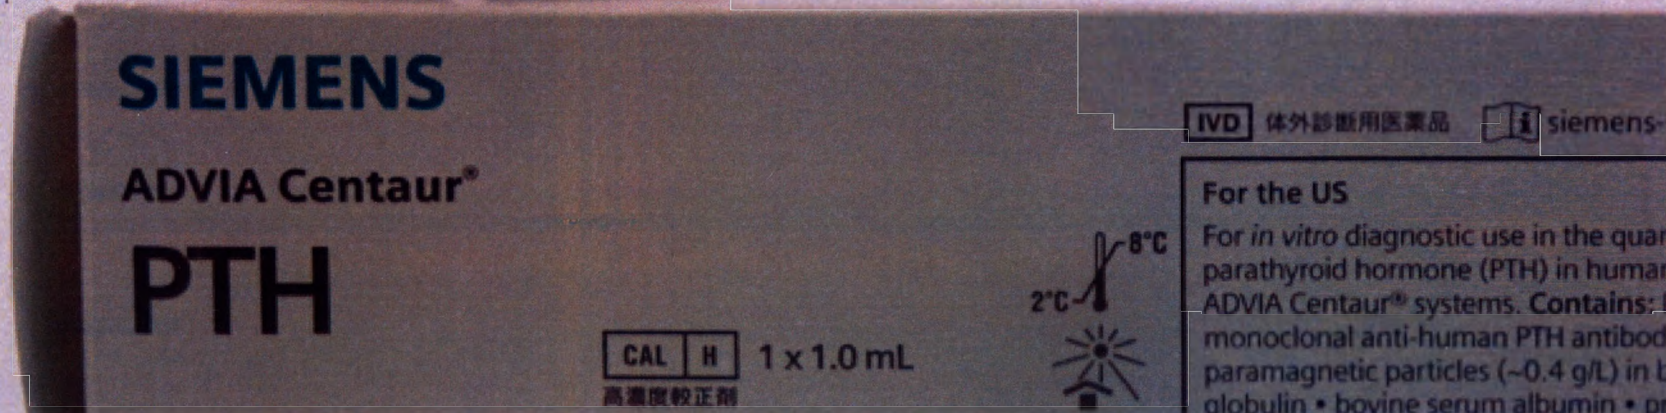
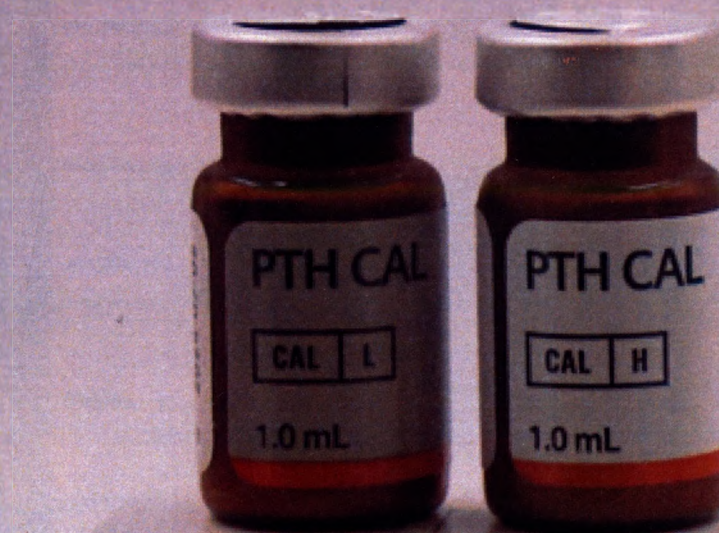


Рисунок 9 Калибратор с низкой концентрацией PTH CAL L, 1,0 мл и Калибратор с низкой концентрацией PTH CAL H, 1,0 мл


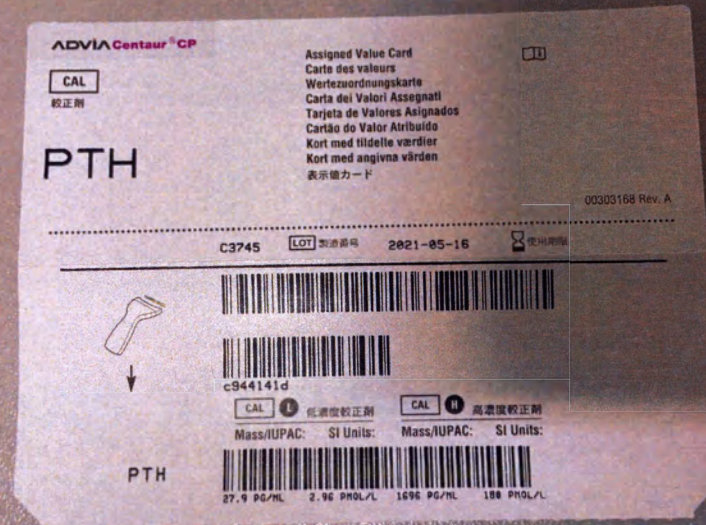


Рисунок 10 Карта значений и этикетки со штрих-кодами ADVIA Centaur PTH



PTN • 139047

ADVIA Centaur®

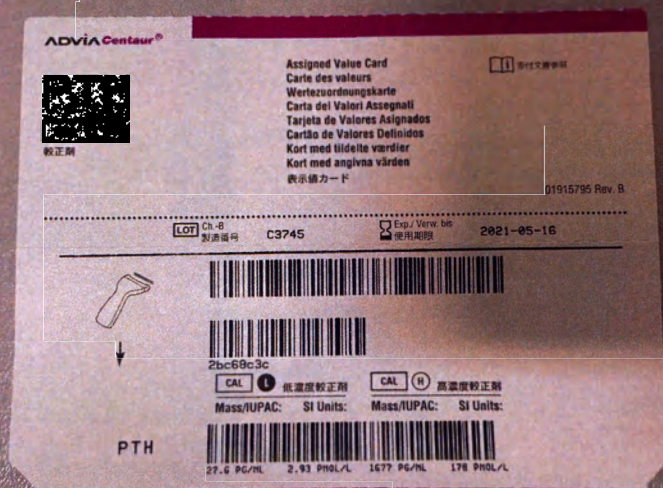

PTH

▶ LOT 製造番号

139047

▶ 有効期限

2021-06-09

MC DEF マスターカーネル検査

LOT DTL LOT 群集

PTH	LOT	DTL

CHECKSUM チェックサム

08ba4f7b

10695521 Rev. A

PTH	LOT	DTL

2.2 0.0417 0.05 0.05 0.05 0.05

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Рисунок 11 Карта эталонной кривой ADVIA Centaur PTH

10699154

Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur: Фасовка 100 тестов

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/15152 от 20.08.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 12 Макет русскоязычной маркировки (фасовка 100 тестов)

10699155

Набор реагентов для определения интактного паратиреоидного гормона (ADVIA Centaur® Intact Parathyroid Hormone (ADVIA Centaur® PTH)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur:
Фасовка 500 тестов

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/15152 от 20.08.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 13 Макет русскоязычной маркировки (фасовка 500 тестов)

Всего прошито и пронумеровано
14 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

