

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»

Денисенко Е.А.
_____ 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов
иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

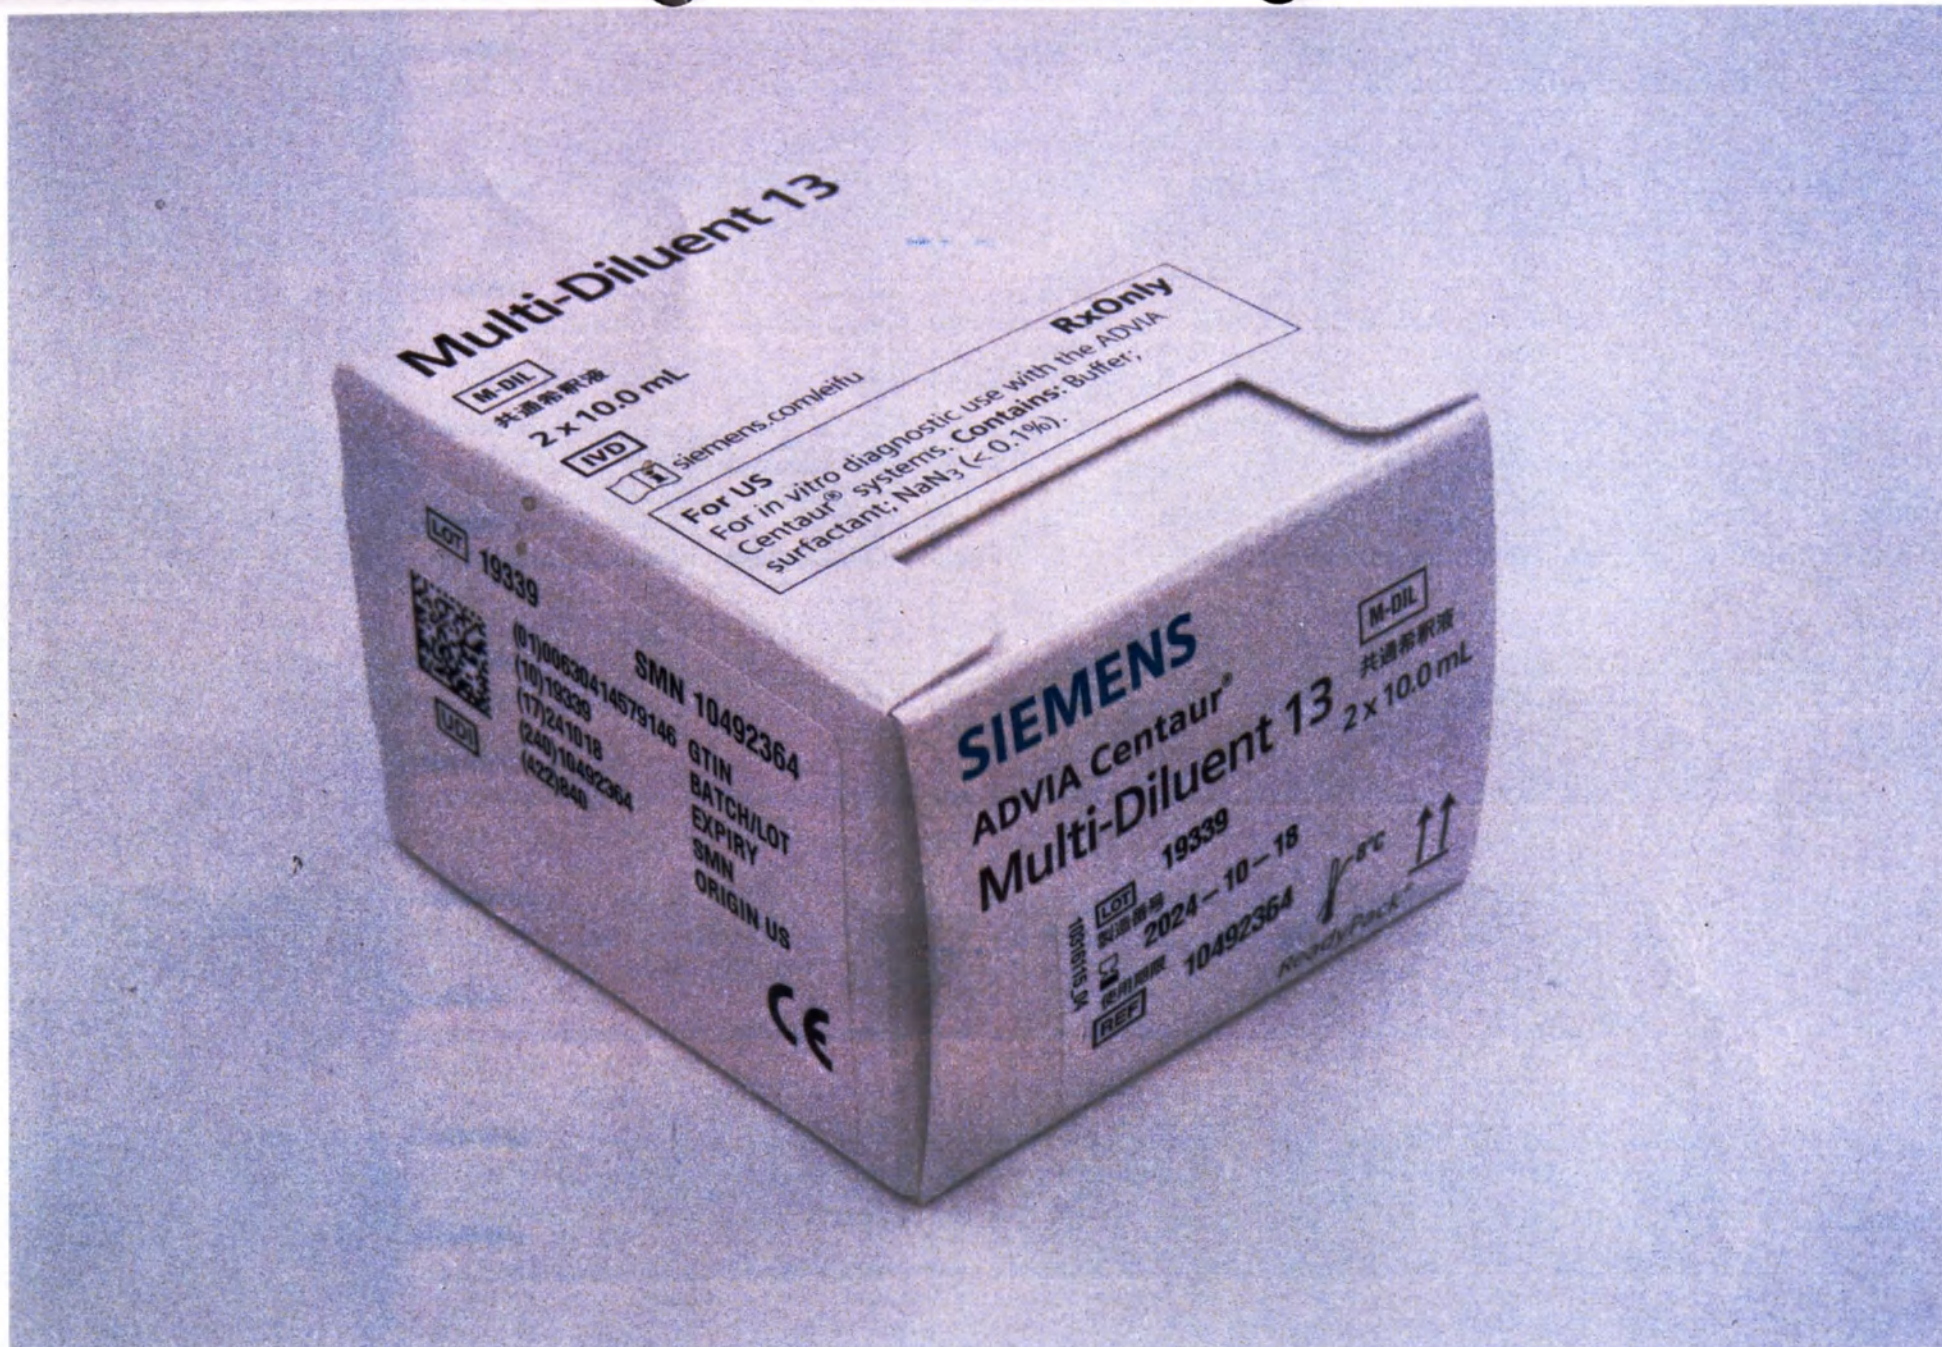


Рисунок 1. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.

Multi-Diluent 13

M-DIL

共通希釈液

2 x 10.0 mL

IVD

 siemens.com/eifu

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use with the ADVIA Centaur® systems. **Contains:** Buffer; surfactant; NaN₃ (< 0.1%).

Рисунок 2. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.

SIEMENS

ADVIA Centaur®

Multi-Diluent 13

M-DIL

共通希釈液
2 x 10.0 mL

19339

LOT

製造番号

2024-10-18

使用期限

REF

10492364

8°C



ReadyPack®

Рисунок 3. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.

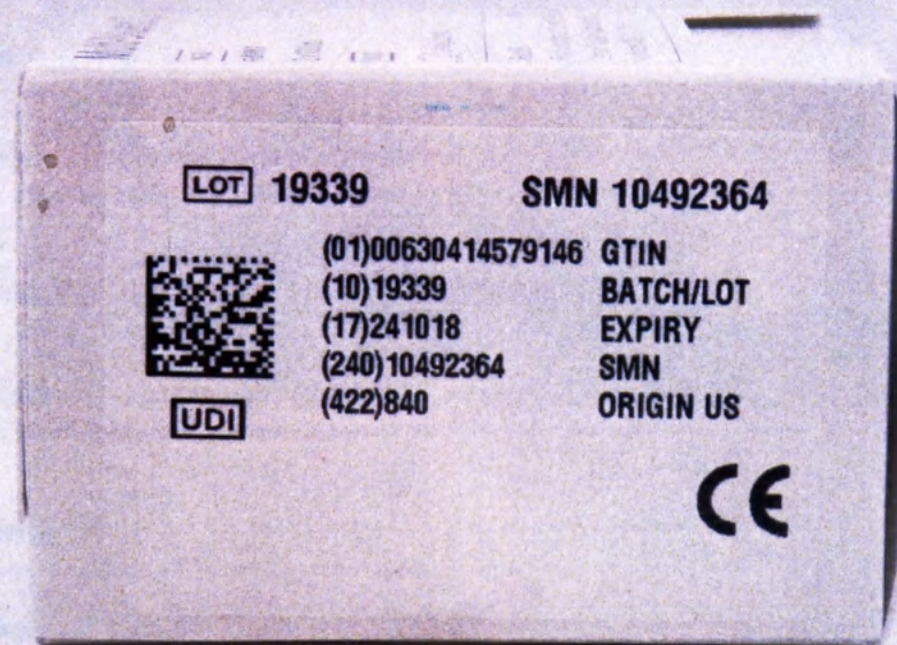


Рисунок 4. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.

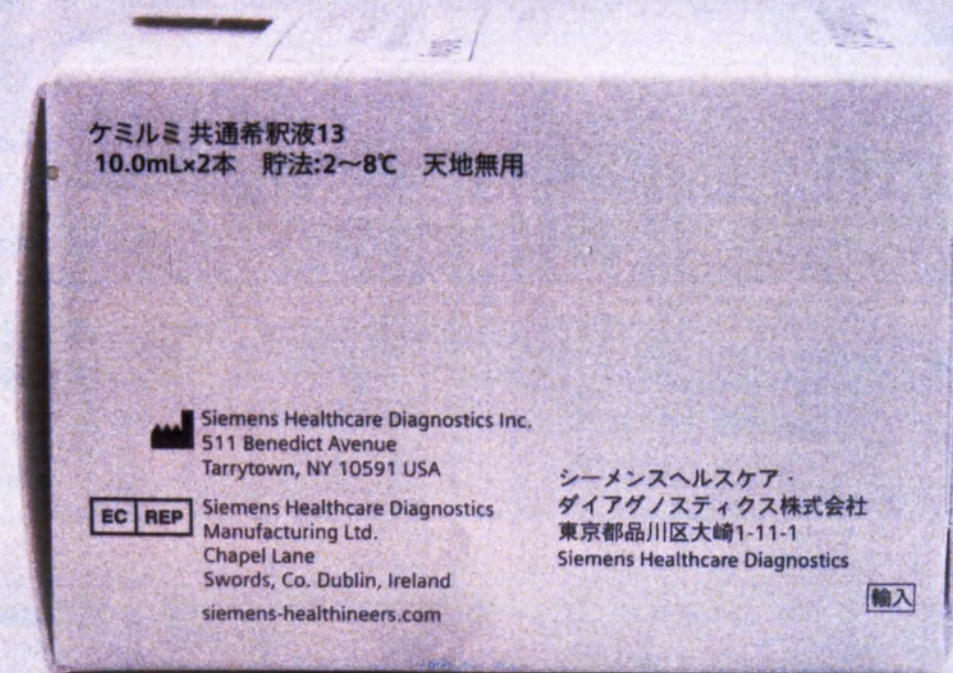


Рисунок 5. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.



17802924
2024-10-18
17802924002503

17802924
2024-10-18
17802924002552

Рисунок 6. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru


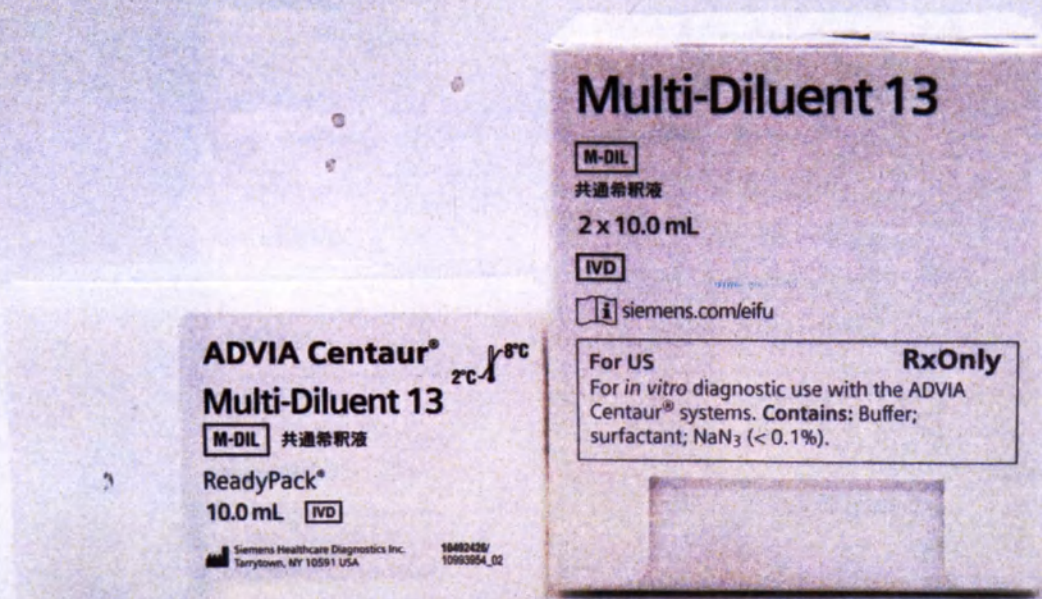


Рисунок 7. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur.

ADVIA Centaur®

Multi-Diluent 13



M-DIL

共通希釈液

ReadyPack®

10.0 mL

IVD



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

10492426/
10993954_02

Рисунок 8. Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur:

10492364 Мульти-Дилуент 13 (ADVIA Centaur® Multi-Diluent 13 (ADVIA Centaur® Multi-Dil 13)) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ PЗН 2021/15194 от 27.08.2021

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
10 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

