

«УТВЕРЖДАЮ»

ИП Макеева Н.В.

Макеева


«01»

2021 г




**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Комплекс рентгеновский маммографический
цифровой МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003,
с принадлежностями», производства Фирма
«РАДМИР» ДП АО НИИРИ, Украина**

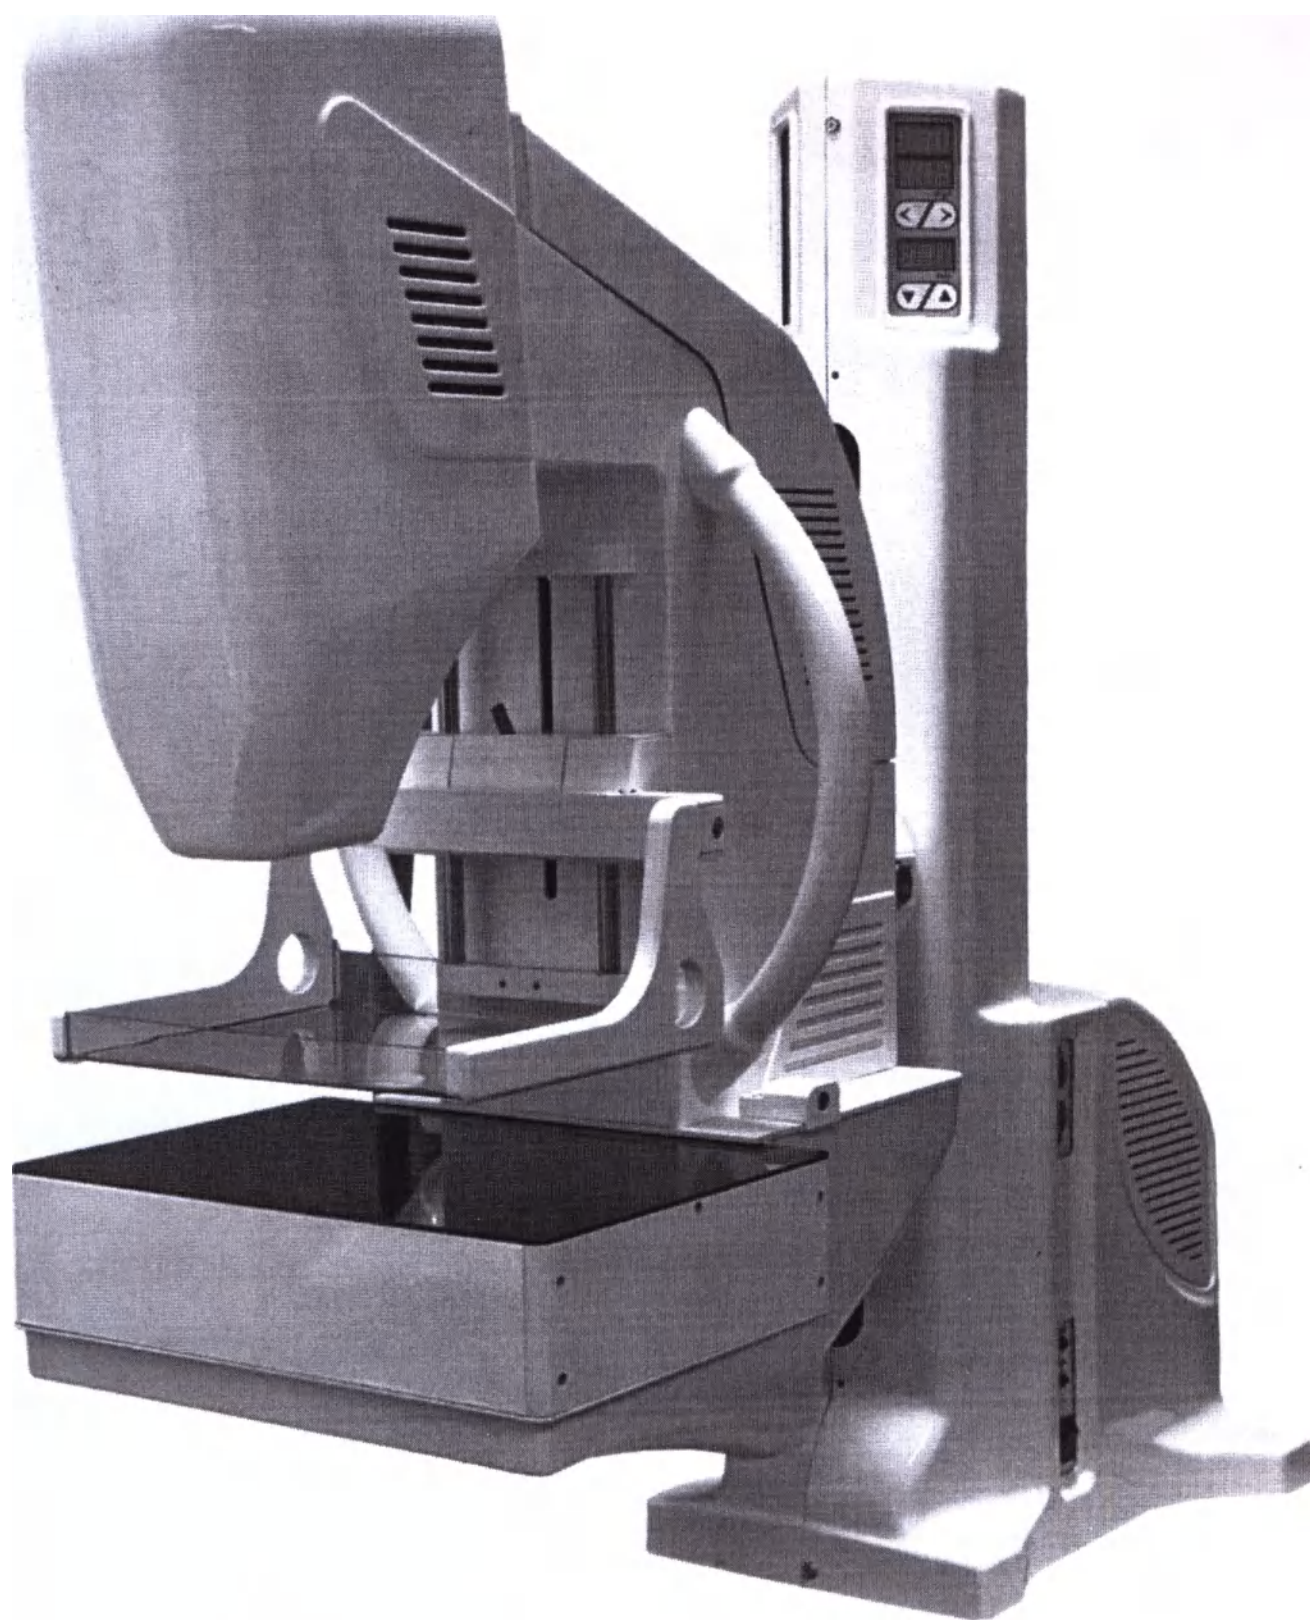

**Рисунок 1 - Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС
ТУ У 33.1-14309534-118-2003. Устройство рентгеновское штативное со встроенной
рентгеновской трубкой 0,006БД24-45**

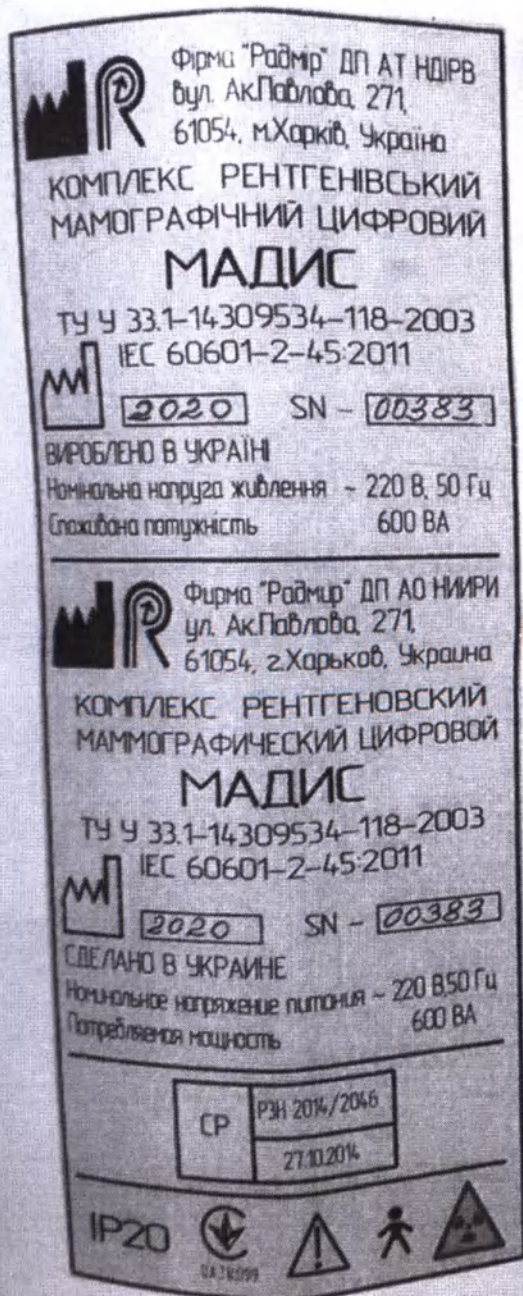

**Рисунок 2 – Маркировочная планка комплекса маммографического цифрового МАДИС
 ТУ У 33.1-14309534-118-2003**

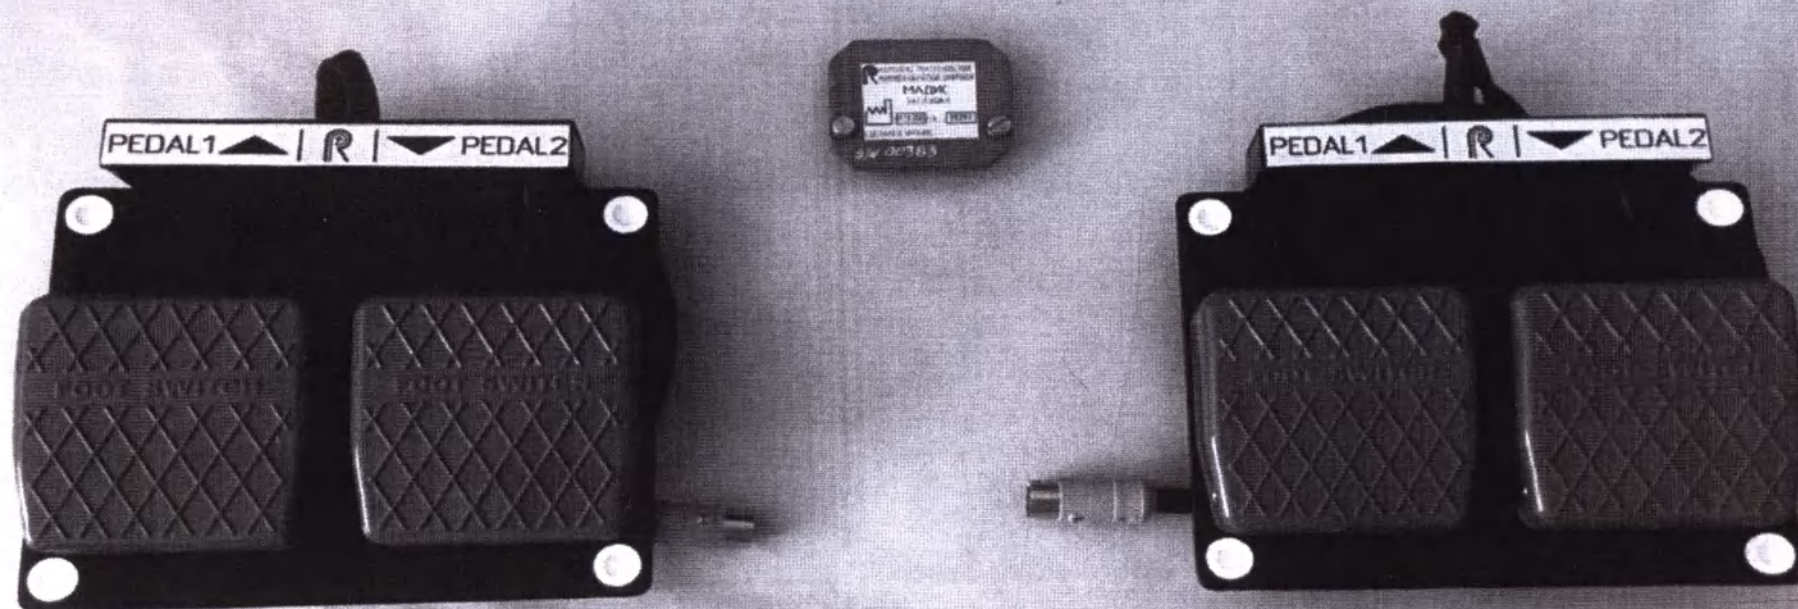

1 – Педали 2 – Заглушка

Рисунок 3


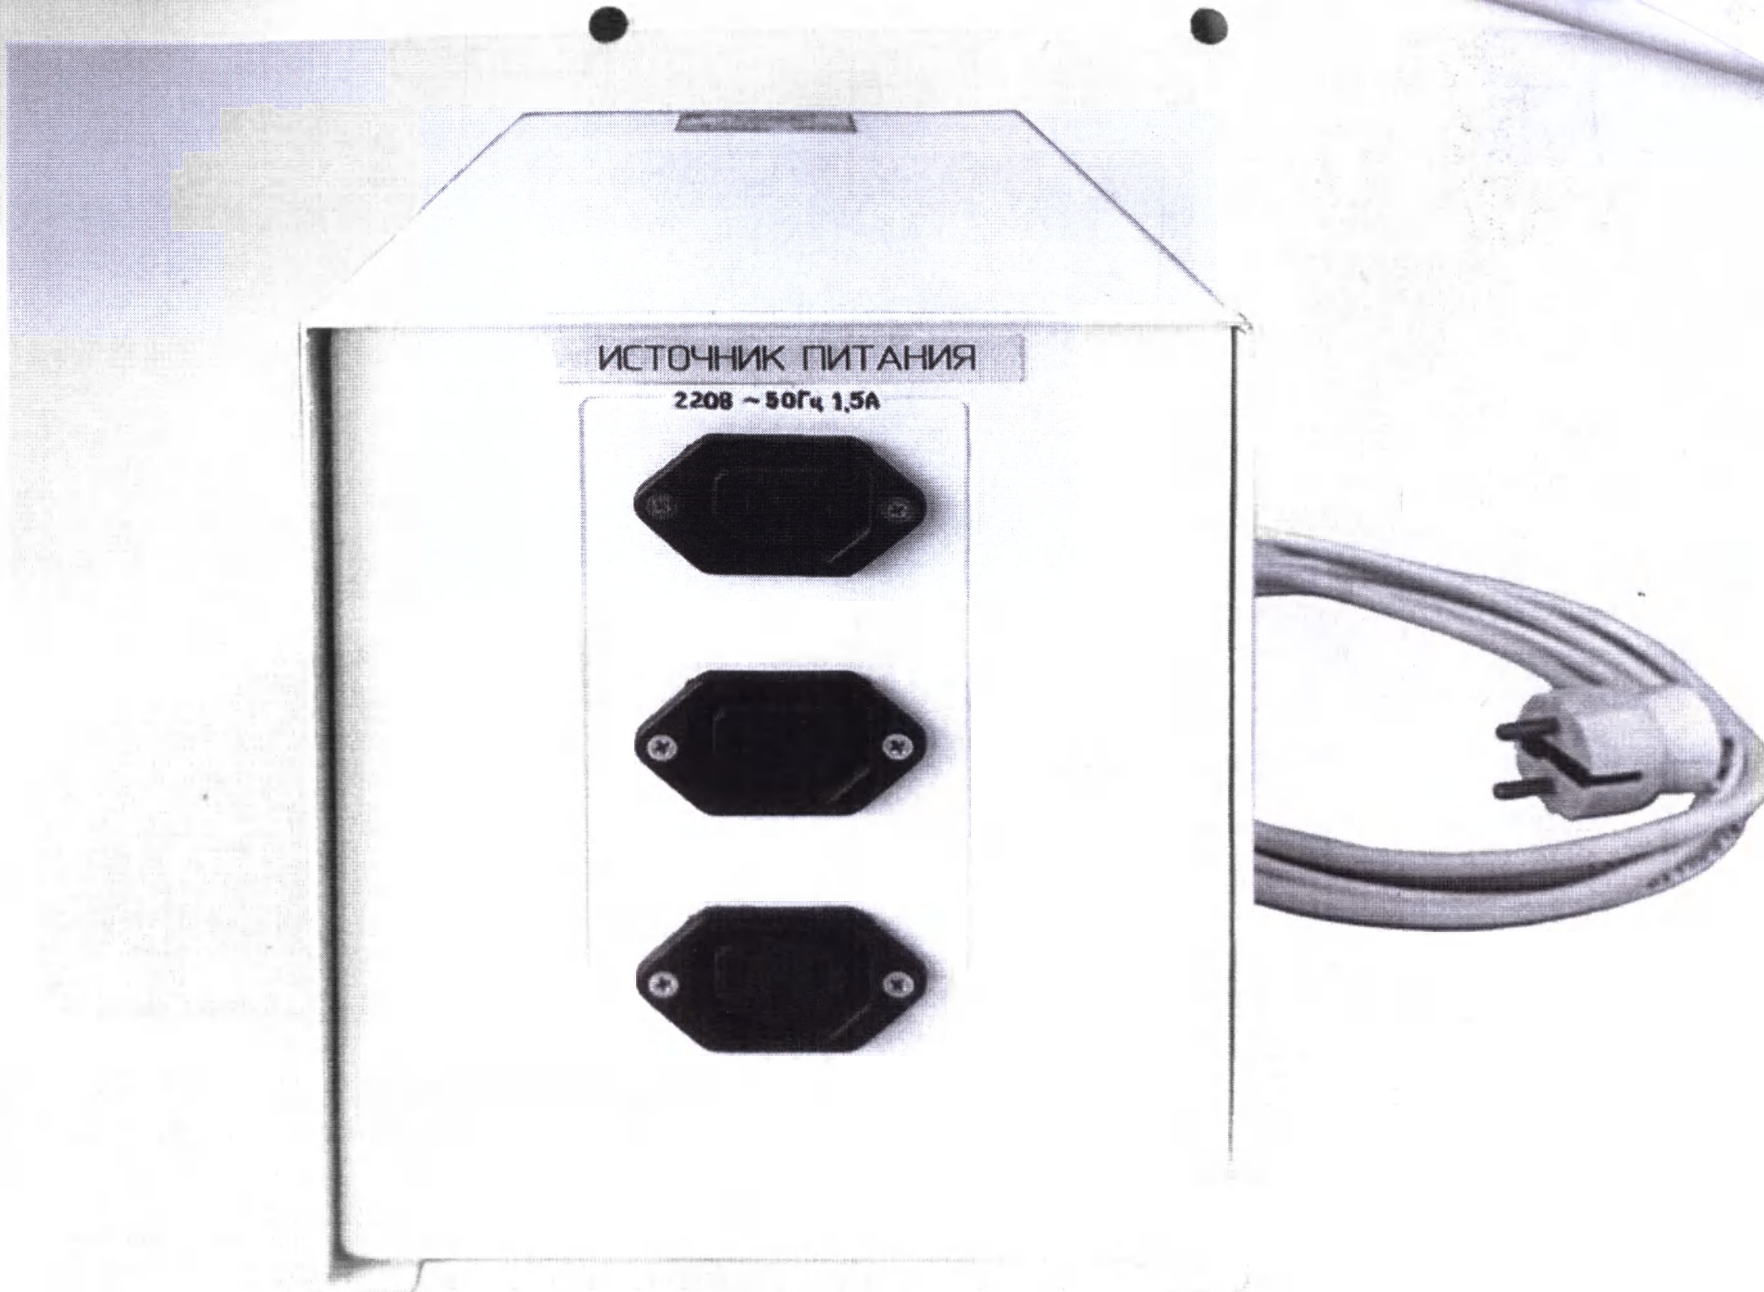


Рисунок 4 – Источник питания

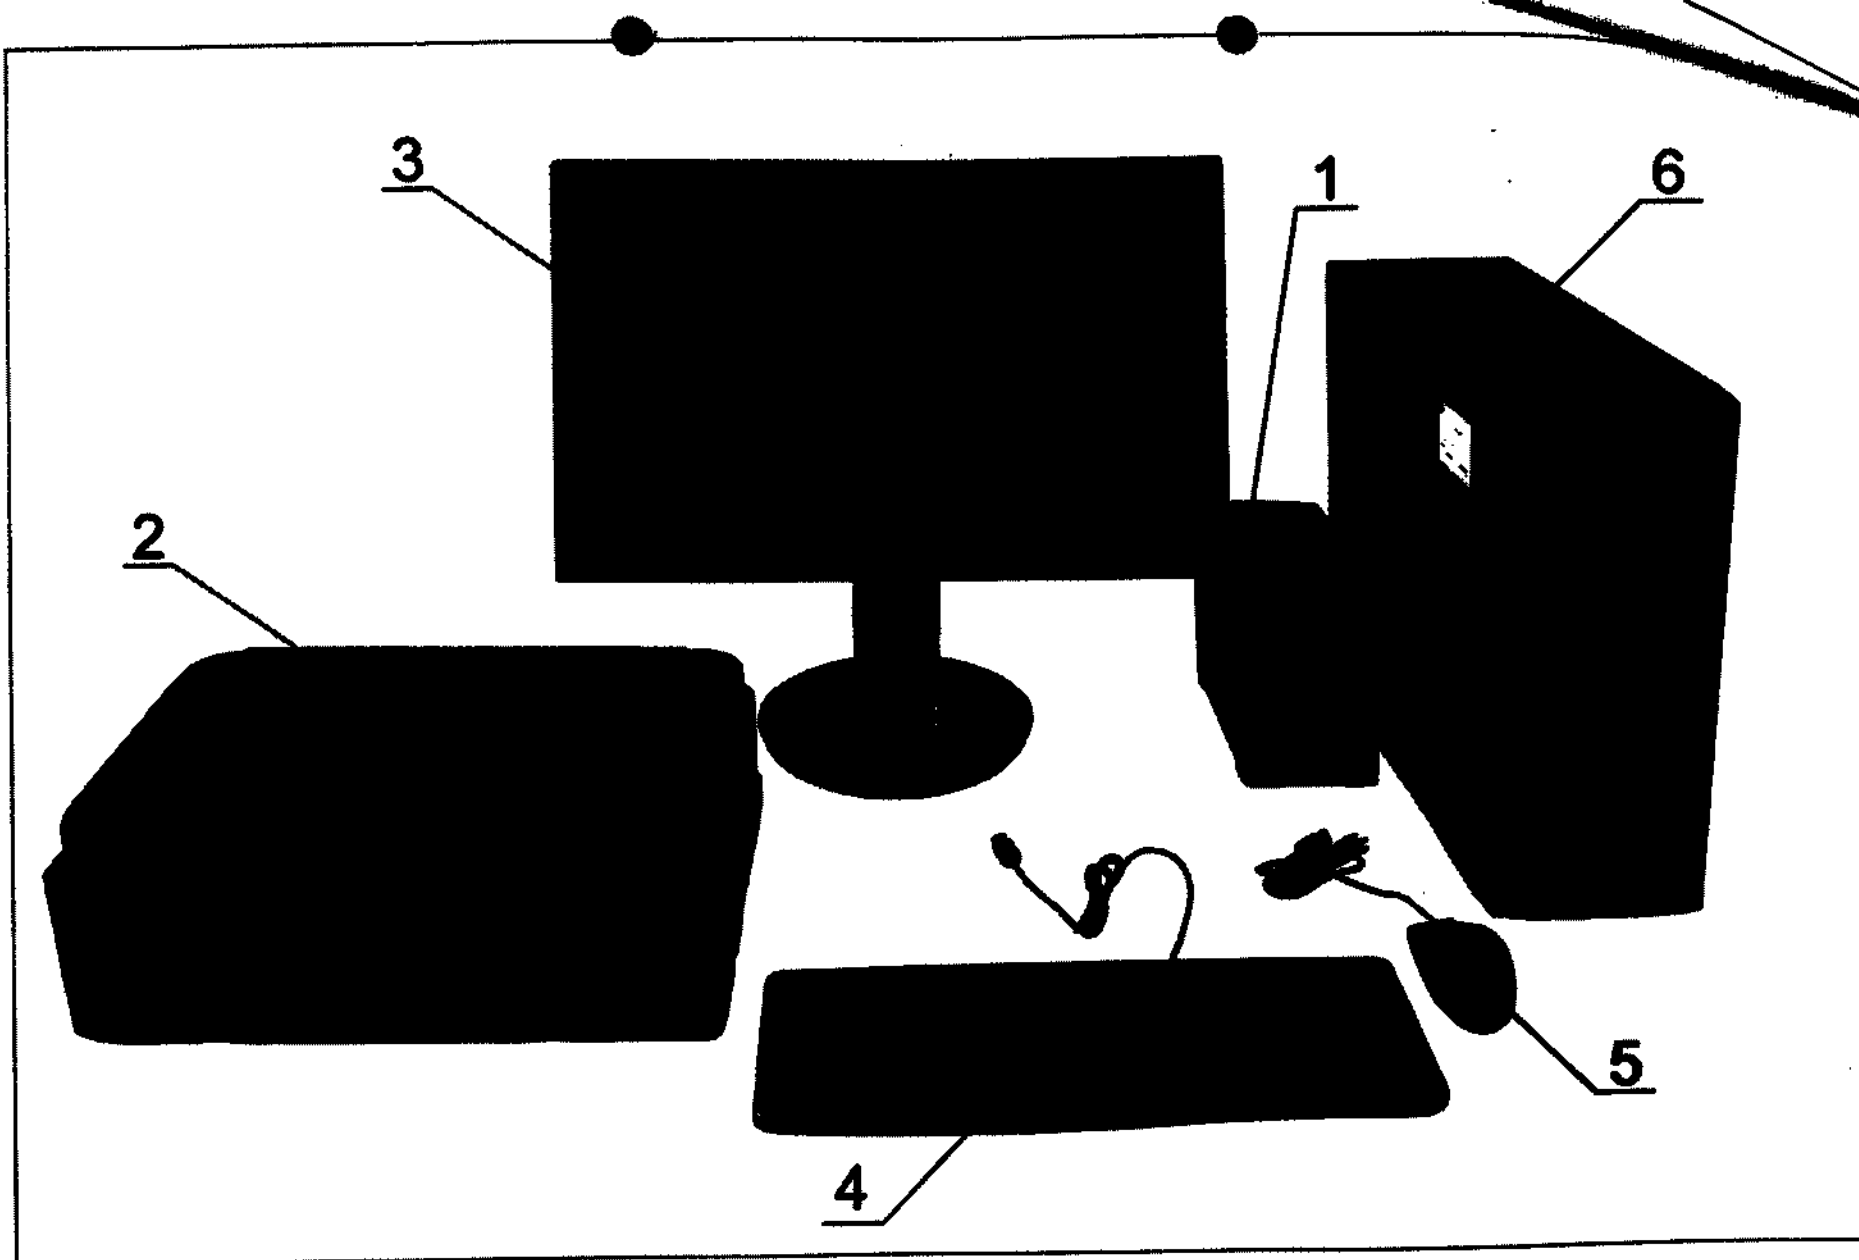

1 – Источник бесперебойного питания
2 – Принтер
3 – Монитор

4 – Клавиатура
5 – Манипулятор «Мышь»
6 – Системный блок

Рисунок 5



1 – Кабель LAN
2 – CD диск с ПМО

3 – Разветвитель сетевой
4 – Кабель USB
Рисунок 6

5 – Кабель

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(7/с. 06/)
ЛИСТОВ

ИП Макеева Н.В.



Прошито, пронумеровано
(138) листов
Скреплено печатью ЦКБ РАН
Зам. гл. врача
Алехин А.И.




«УТВЕРЖДАЮ»

ИП ~~Максимова Н.В.~~



Фотографические изображения
медицинского изделия


«Комплекс рентгеновский маммографический
цифровой МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003,
с принадлежностями», производства Фирма
«РАДМИР» ДП АО НИИРИ, Украина

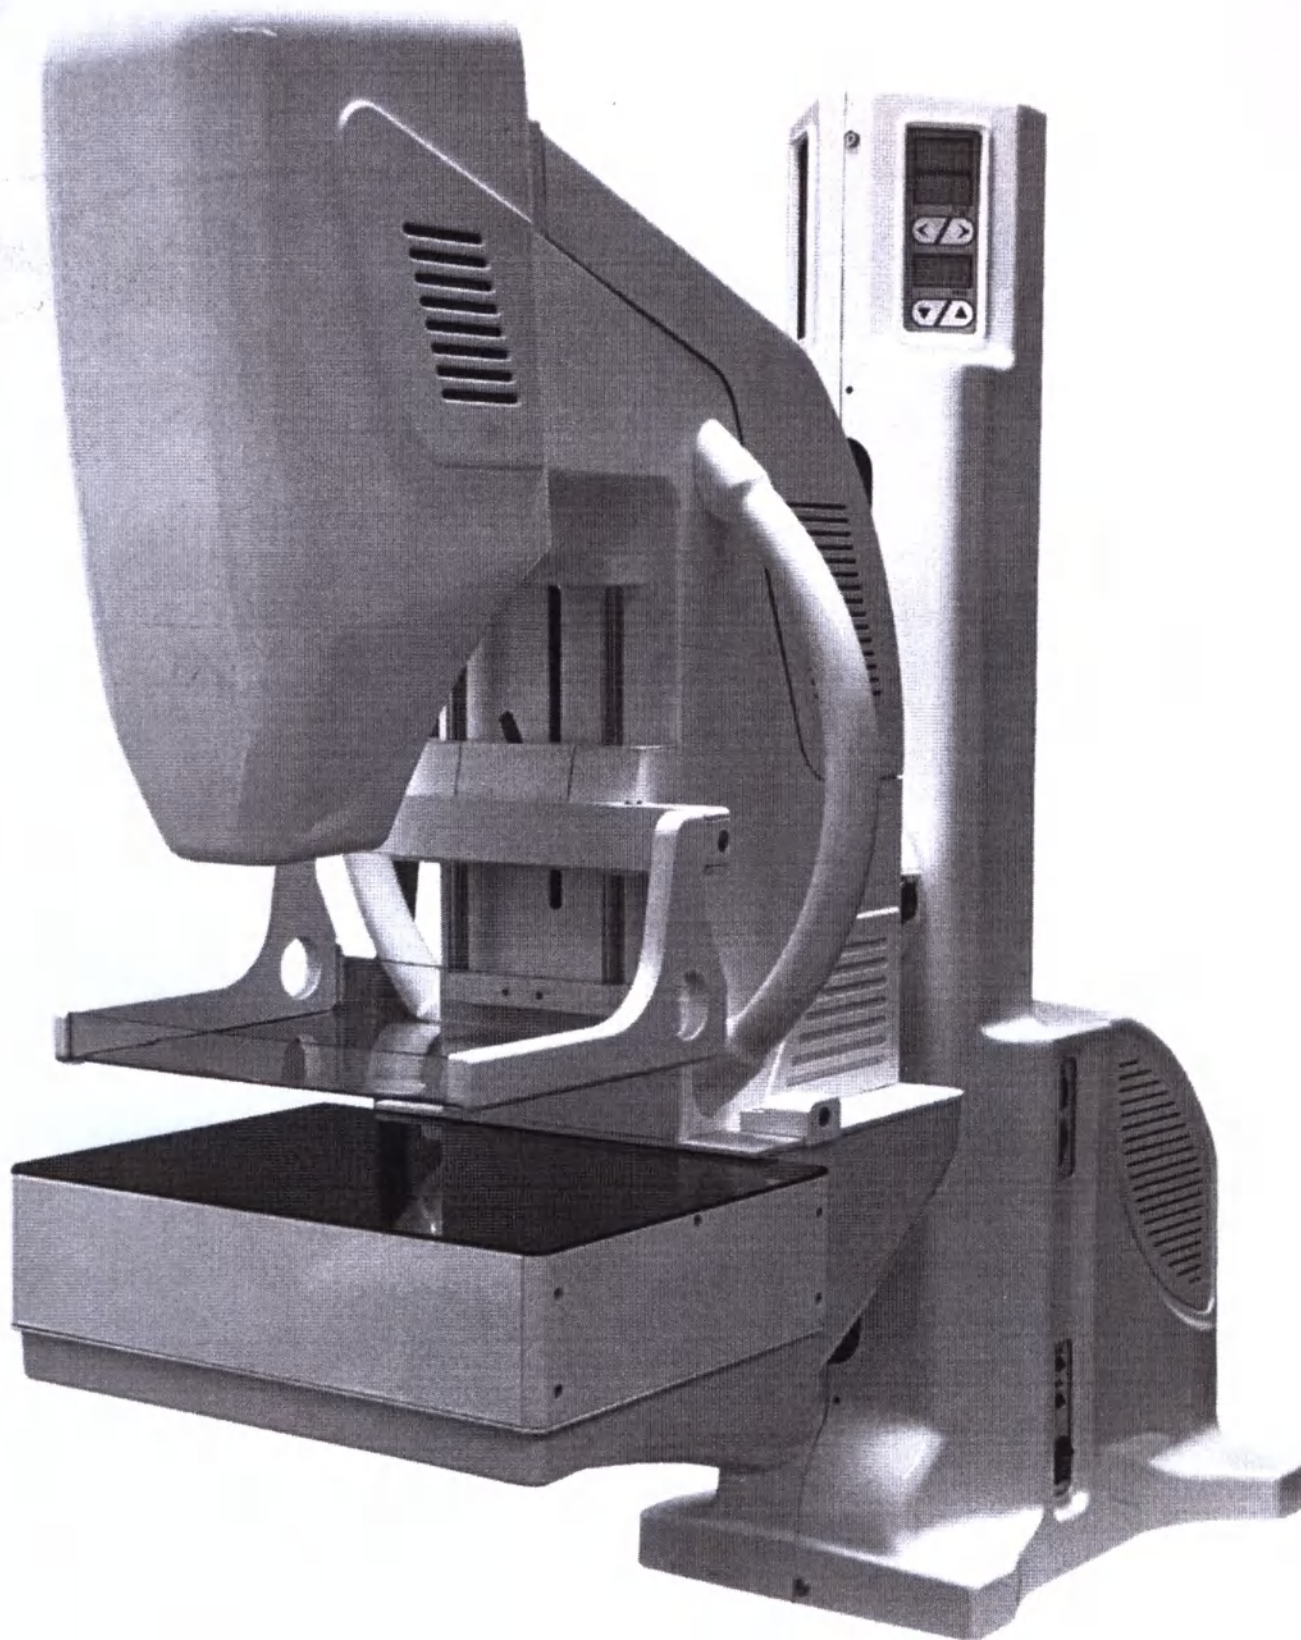

**Рисунок 1 - Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС
ТУ У 33.1-14309534-118-2003. Устройство рентгеновское штативное со встроенной
рентгеновской трубкой 0,006БД24-45**



Рисунок 2 – Маркировочная планка комплекса маммографического цифрового МАДИС
ТУ У 33.1-14309534-118-2003

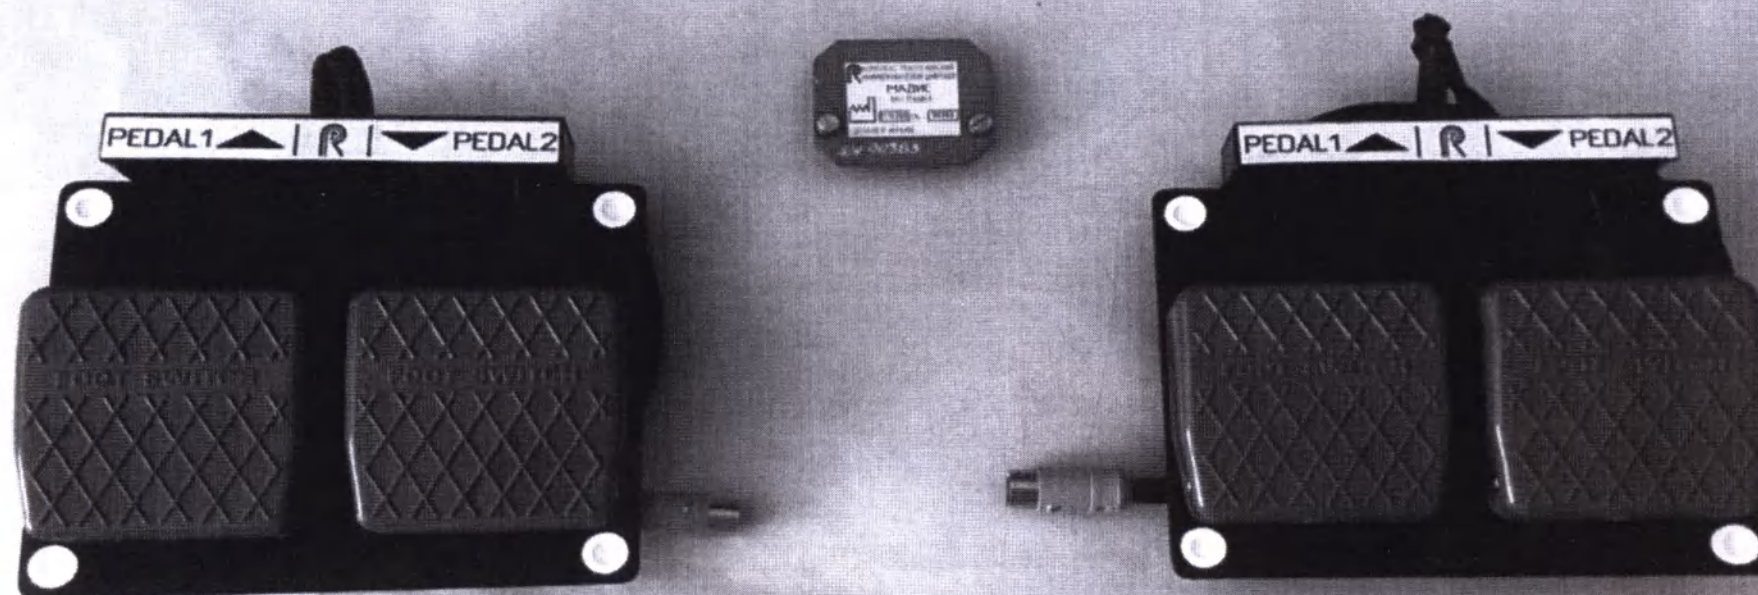

1 – Педали 2 – Заглушка

Рисунок 3


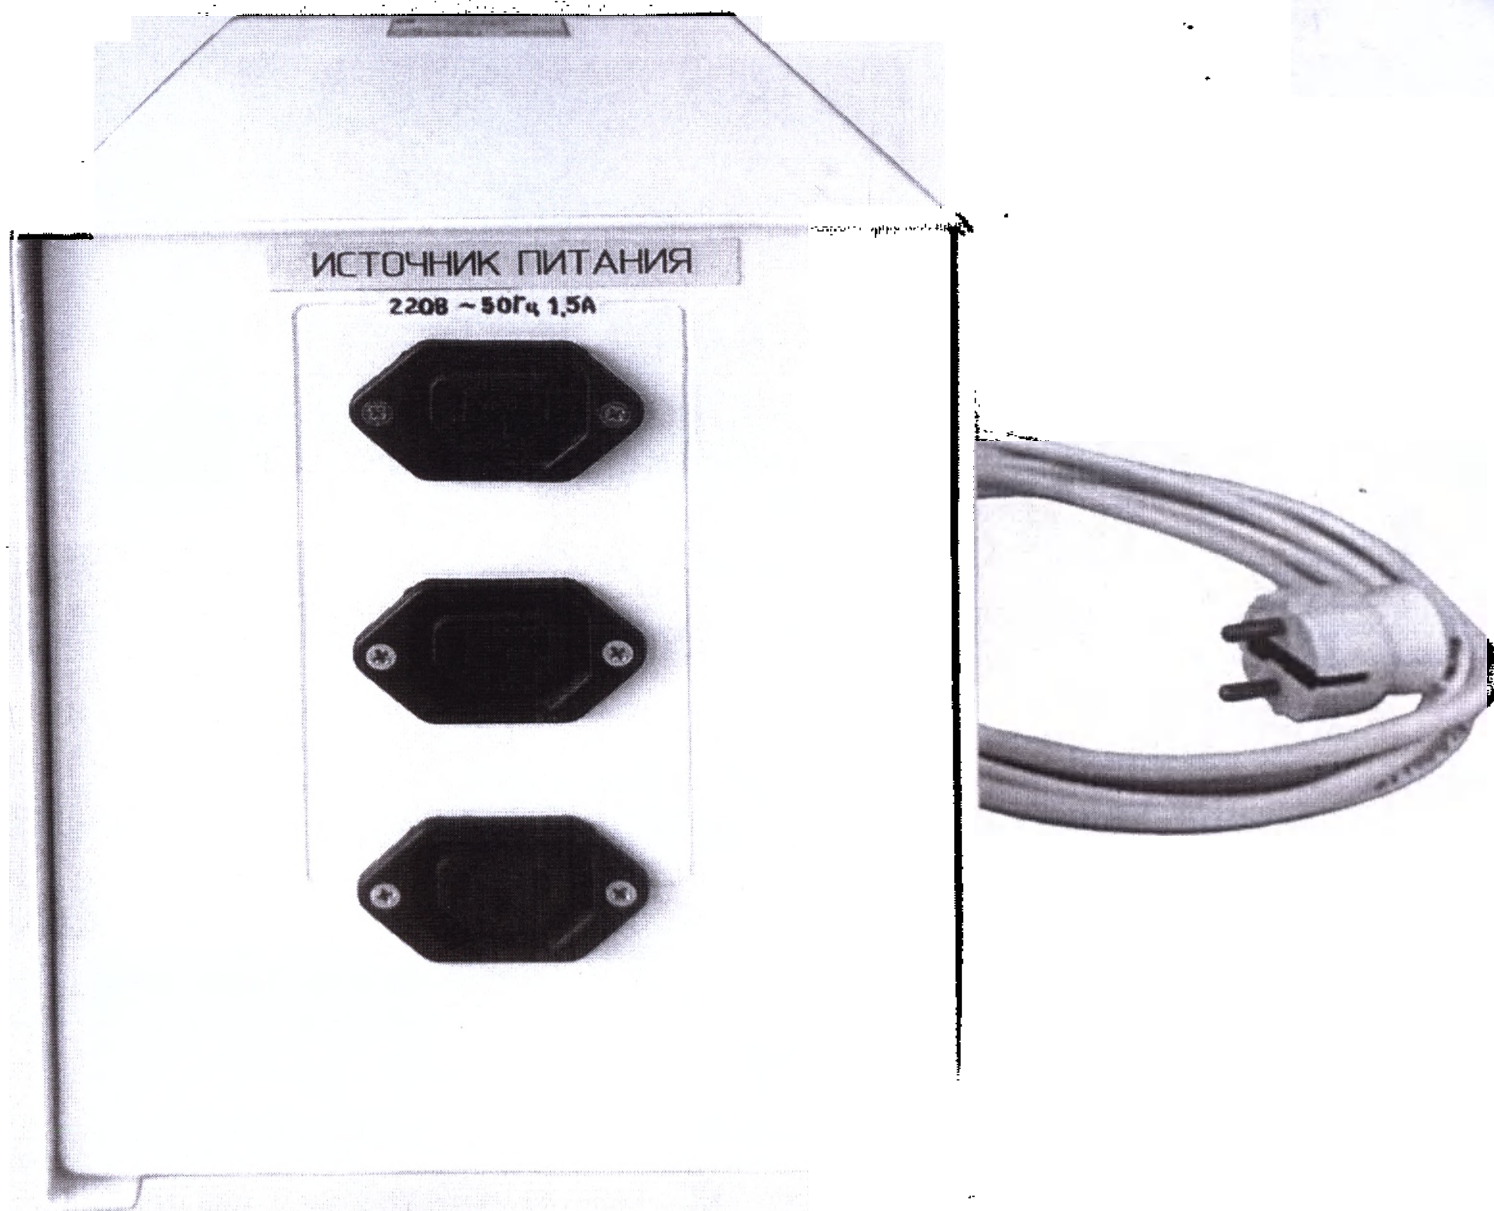



Рисунок 4 – Источник питания

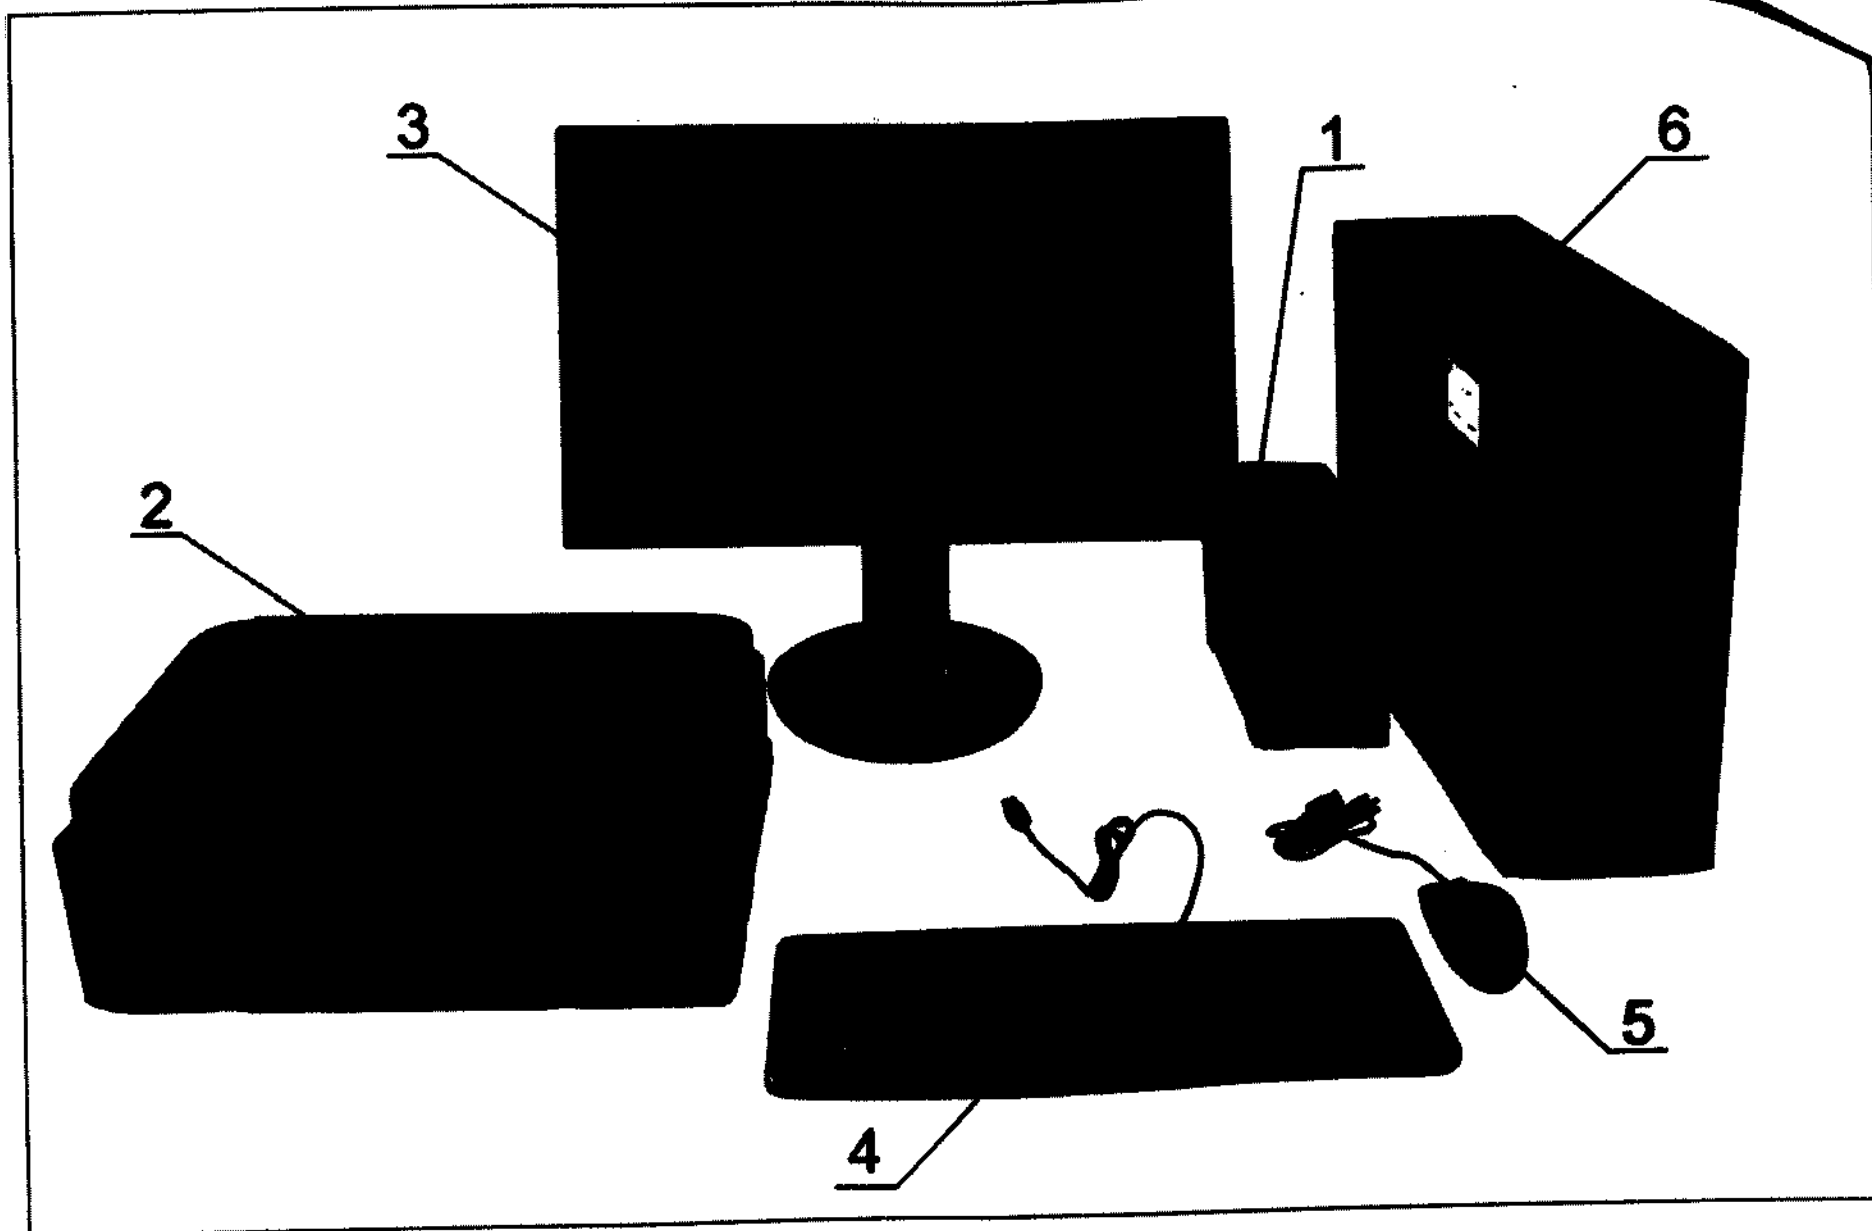

1 – Источник бесперебойного питания
2 – Принтер
3 – Монитор

4 – Клавиатура
5 – Манипулятор «Мышь»
6 – Системный блок

Рисунок 5

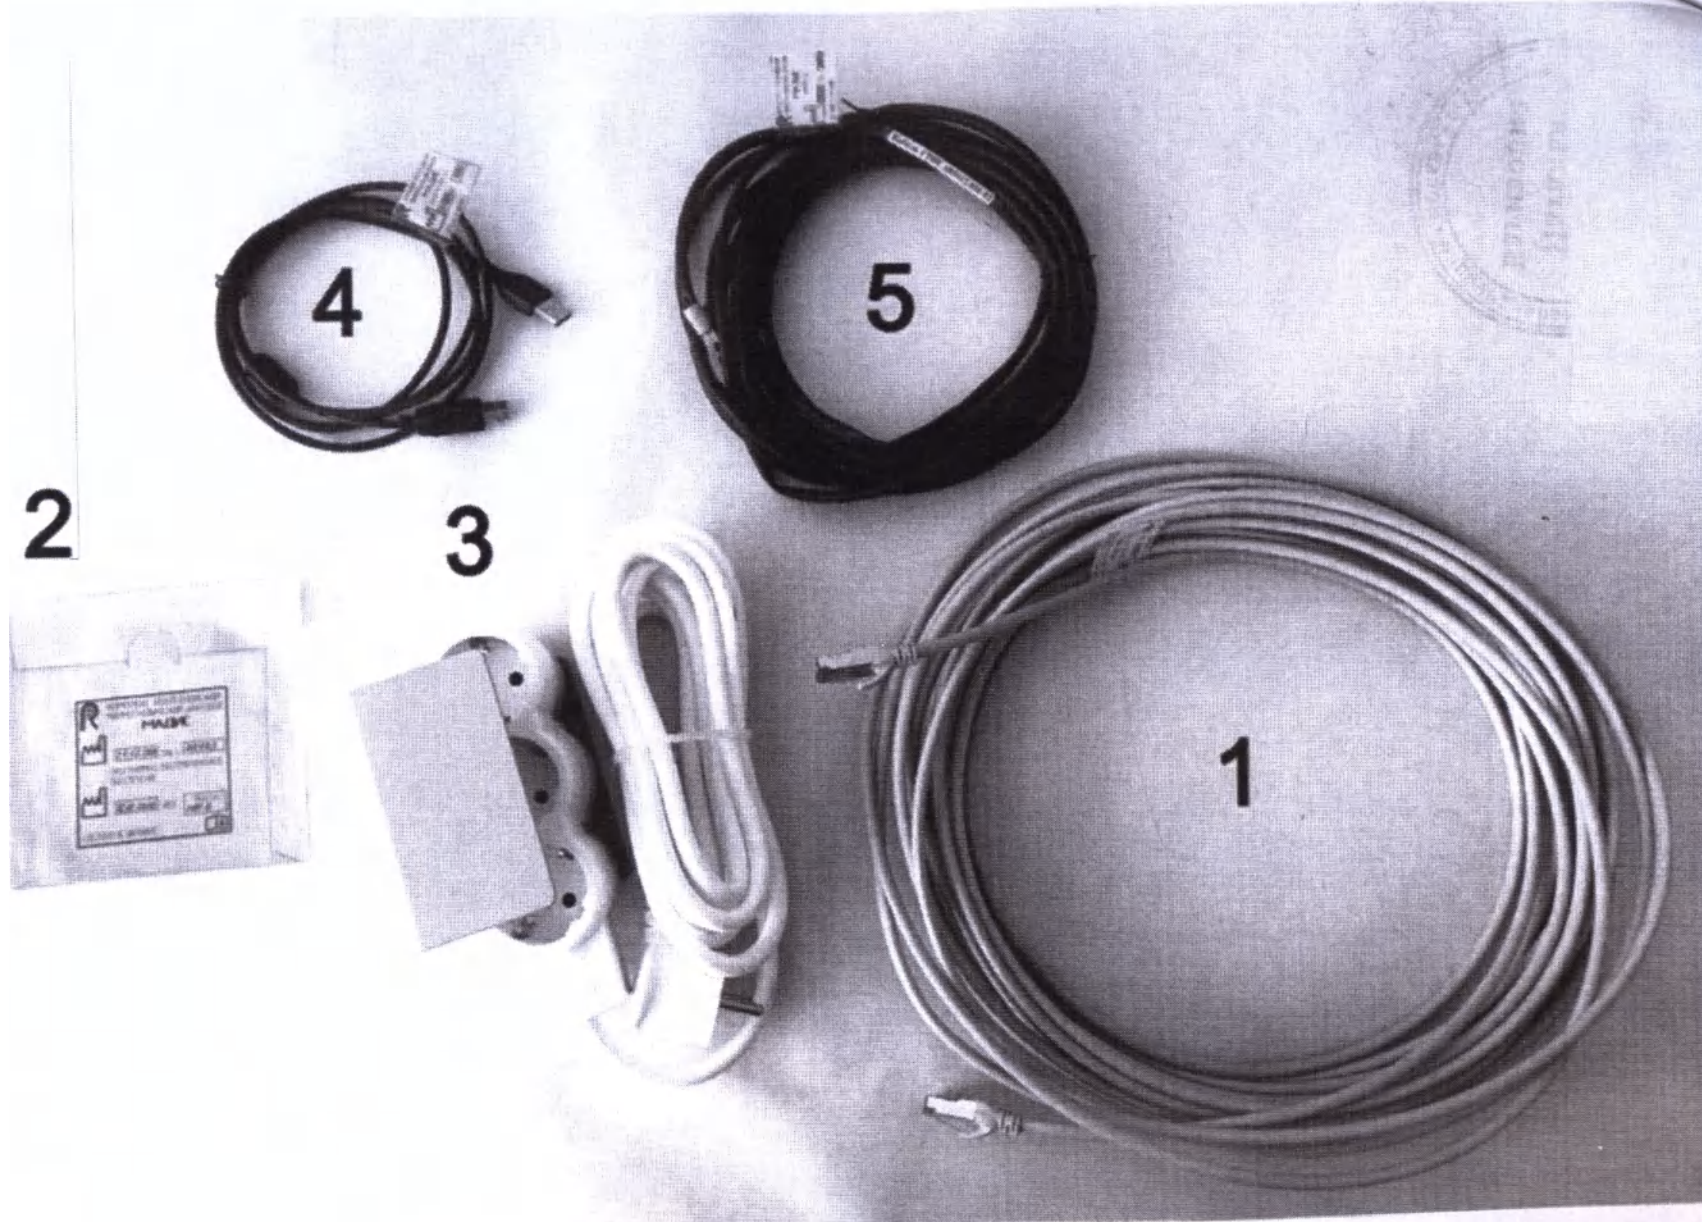

1 – Кабель LAN
2 – CD диск с ПМО

3 – Разветвитель сетевой
4 – Кабель USB
Рисунок 6

5 – Кабель

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7
(ссылка)

листов



«УТВЕРЖДАЮ»

ИП Макеева Н.В.



**Проект маркировки для РФ
медицинского изделия**

**«Комплекс рентгеновский маммографический
цифровой МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003,
с принадлежностями», производства Фирма
«РАДМИР» ДП АО НИИРИ, Украина**

ПРОЕКТ МАРКИРОВОЧНОЙ ПЛАНКИ КОМПЛЕКСА РЕНТГЕНОВСКОГО МАММОГРАФИЧЕСКОГО ЦИФРОВОГО МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003

(на украинском и русском языках)

	Фірма "Радіомір" ДП АТ НДІРВ вул. Ак.Павлова, 271, 61054, м.Харків, Україна			
КОМПЛЕКС РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МАМОГРАФІЧНИЙ ЦИФРОВИЙ МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003 ІЕС 60601-2-45:2011				
	SN -			
ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ Номинальна напруга живлення ~ 220 В, 50 Гц Споживана потужність 600 ВА				
	Фірма "Радіомір" ДП АО НДІРМ вул. Ак.Павлова, 271, 61054, м.Харьков, Україна			
КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ МАМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ МАДИС ТУ У 33.1-14309534-118-2003 ІЕС 60601-2-45:2011				
	SN -			
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ Номинальное напряжение питания ~ 220 В 50 Гц Потребляемая мощность 600 ВА				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%;">СР</td> <td>РЗ-2014-12046</td> </tr> <tr> <td>27102004</td> </tr> </table>		СР	РЗ-2014-12046	27102004
СР	РЗ-2014-12046			
	27102004			
IP20				

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2

ЛИСТОВ

